

**Фотографические изображения внешнего вида нового варианта исполнения
медицинского изделия**

**Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 500г, рулон**

2024г

Изготовитель: Акционерное общество
"Фабрика медицинских изделий и материалов
"Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства / Организация,
принимаящая претензии: АО "Фабрика
"Ника", Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94,
e-mail: mail@fabrika-nika.ru

**ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ 500^{±20}**



НЕСТЕРИЛЬНАЯ 500²

РЕГ. УД. № РЗН 2013/229 от 26.06.2018 г.



СРОК ГОДНОСТИ 6 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств. Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: использовать в составе перевязочного средства однократного применения. Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности. Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Масса пачки (500±20)г при влажности ваты 8%. **Состав:** Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения S(OЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.

ПАРТИЯ 01

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ март 2024г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая


500 ± 20 г

нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.


Рег. Уд. № РЗН 2013/229
от 26.06.2019 г.

Внешний вид транспортной упаковки ваты медицинской гигроскопической хирургической нестерильной по ТУ 9393-004-31039208-2012, 500г, рулоны.

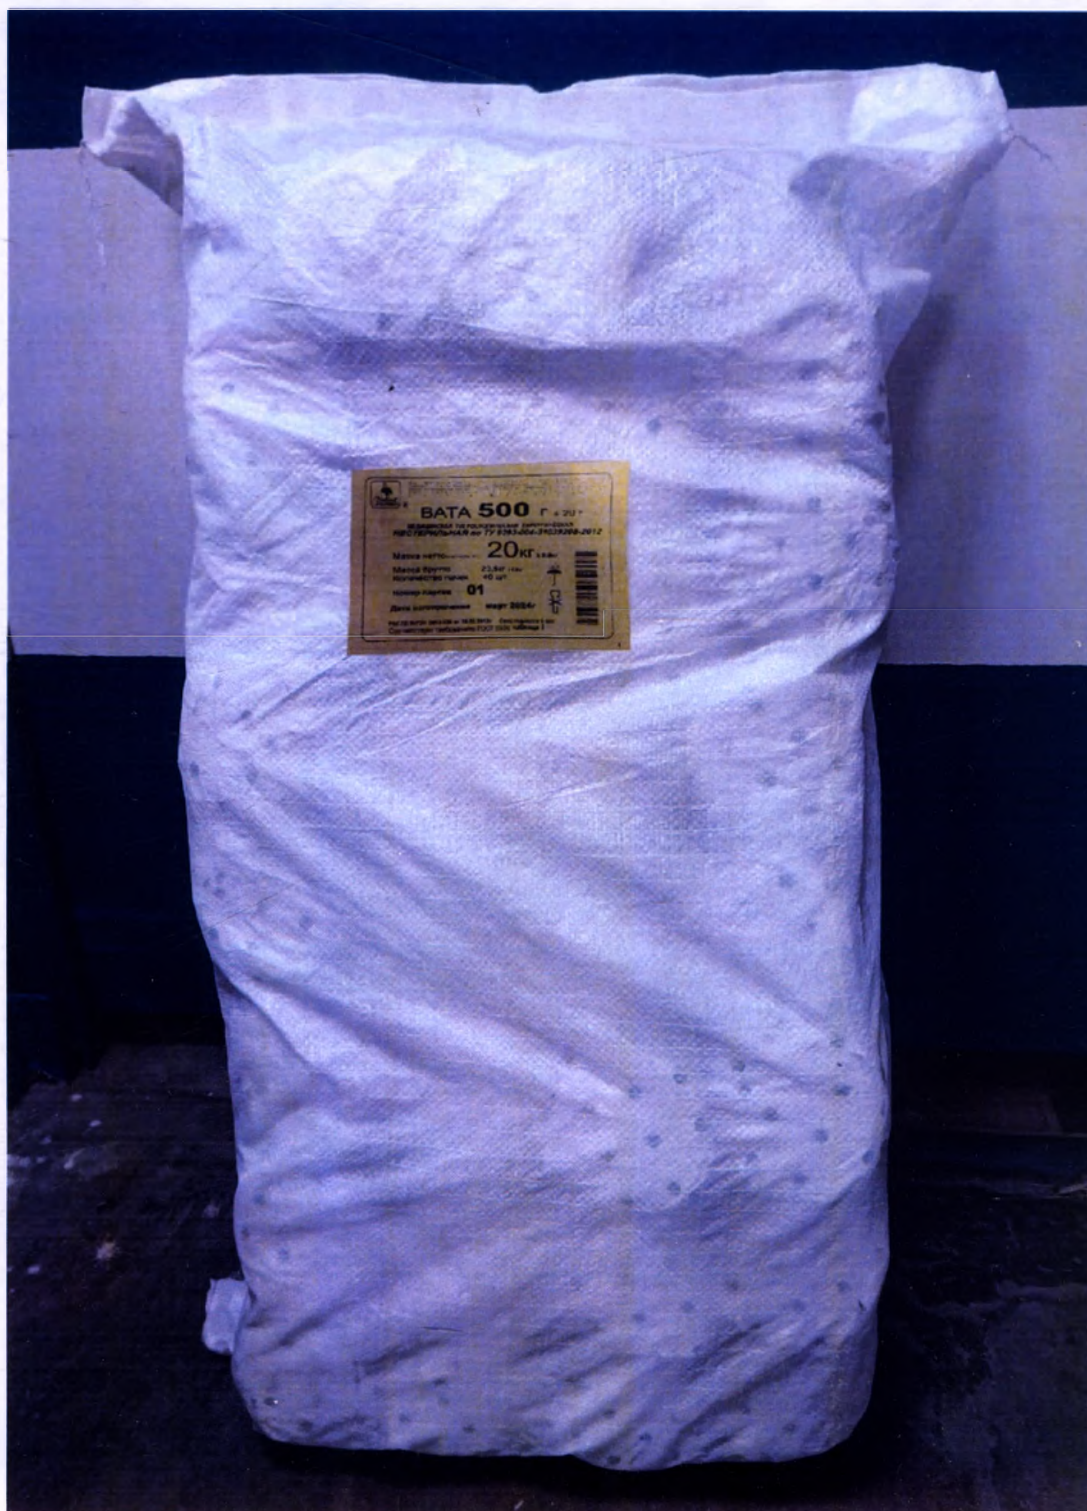

Счито и заверено печатью
6 (шесть) листов.

Директор АО «Фабрика «Ника»

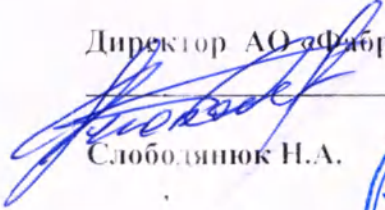
Слободянюк Н.А.



Макеты упаковки всех вариантов исполнения медицинского изделия

**Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012**


2024г

«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

«01» ноября 2024г

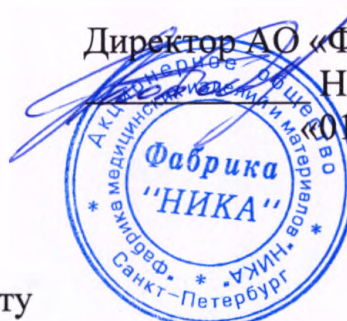

Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 25г, рулон

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий

и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)

Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,

ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.

Место производства / Организация, принимающая претензии:

АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,

ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.

Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229

от 26 июня 2019г



Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

25 ± 2 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012




Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Масса пачки (25±2) г при влажности ваты 8%.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.




номер партии:
дата изготовления:

«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

«01» ноября 2024г



Этикетка на вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 50г, рулон

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 1013/229

от 26 июня 2019г



Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

50 $\pm$ 4 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012




Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Масса пачки (50 $\pm$ 4) г при влажности ваты 8%.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.



Номер партии:
Дата изготовления:

«Утверждаю»



Директор АО «Фабрика «Ника»
Н.А.Слободянюк
«01» ноября 2024г

Этикетка на вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 100г, рулон

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229
от 26 июня 2019г



вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

100 $\pm$ 5 г



нестерильная


по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Масса пачки (100 $\pm$ 5) г при влажности ваты 8%.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.



Номер партии:
Дата изготовления:

«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Слободянюк Н.А.
«01» ноября 2024г



Этикетка на вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную по
ТУ 9393-004-31039208-2012, 200г, рулон.

Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ 200^{±10}₂

РЕГ.УД. № РЗН 2013/229 от 26.06.2019 г.



СРОК ГОДНОСТИ 6 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств. Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: использовать в составе перевязочного средства однократного применения. Не использовать вату, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности. Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Масса пачки (200±10)г при влажности ваты 8%. **Состав:** Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.

ПАРТИЯ _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____

«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

«01» ноября 2024г



Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 250г, рулон

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)

Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.

Место производства / Организация, принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.

Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru



вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

250 ± 10 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012



Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Рег. уд. № РЗН 2013/229

от 26 июня 2019г

Масса пачки (250±10) г при влажности ваты 8%.


Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.



Номер партии:
Дата изготовления:

«Утверждаю»
Директор АО «Фабрика «Ника»
Сабодьянюк Н.А.
01 ноября 2024г

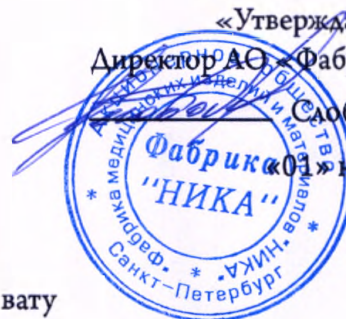

Этикетка на вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную по
ТУ 9393-004-31039208-2012, 500г, рулон.

Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

БАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ 500^{±20}₂

РЕГ.УД. № РЗН 2013/229 от 26.06.2019 г.



СРОК ГОДНОСТИ 6 ЛЕТ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012
Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств. Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: использовать в составе перевязочного средства однократного применения. Не использовать вату, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности. Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Масса пачки (500±20)г при влажности ваты 8%. **Состав:** Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%


Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.

ПАРТИЯ _____

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____

«Утверждаю»

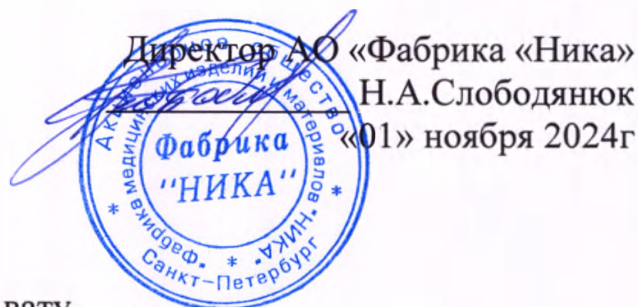

Этикетка на вату
медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 500г, рулон

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru



вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

500 ± 20 г



нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Рег. уд. № РЗН 2013/229

от 26 июня 2019г


Масса пачки (500±20) г при влажности ваты 8%.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.



Номер партии:
Дата изготовления:

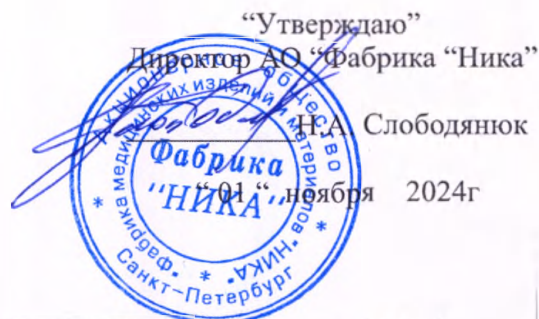

Макет этикетки на вату медицинскую гигроскопическую
хирургическую нестерильную по ТУ 9393-004-31039208-2012,
1000г, рулон



Изготовитель: АО “Фабрика “Ника”

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5Н, ком.1.
Место производства: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н, тел. 8(812)786-45-94, 8(812)252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БАТА (1000 ± 50) г
медицинская гигроскопическая
хирургическая **НЕСТЕРИЛЬНАЯ**
по ТУ 9393-004-31039208-2012

Дата изготовления _____ Партия _____

Предназначена для использования в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Состав

волокно хлопковое - не менее 30%

волокно химическое - не более 70%

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: Взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.


Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.


Утилизировать использованную вату по СанПиН 2.1.3684-21. Упаковку, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид утилизировать с бытовыми отходами.

Срок годности 6 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения .

РУ №РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 таблица 1



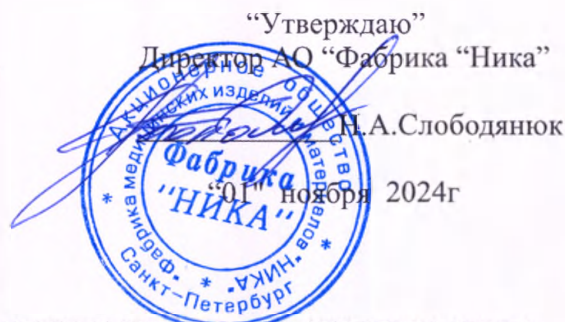

Макет этикетки на вату медицинскую гигроскопическую
хирургическую нестерильную по ТУ 9393-004-31039208-2012,
2500г, рулон



Изготовитель: АО “Фабрика “Ника”

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5Н, ком.1.
Место производства: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н, тел. 8(812)786-45-94, 8(812)252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

ВАТА (2500 ± 100)г
*медицинская гигроскопическая
хирургическая НЕСТЕРИЛЬНАЯ
по ТУ 9393-004-31039208-2012*

Дата изготовления _____ Партия _____

Предназначена для использования в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Состав

волокно хлопковое - не менее 30%

волокно химическое - не более 70%

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: Взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте


в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизировать использованную вату по СанПиН 2.1.3684-21. Упаковку, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид утилизировать с бытовыми отходами.

Срок годности 6 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения .

РУ №РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 табл.1



«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

«01» ноября 2024г



Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 50г, зиг-заг

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг

50 Г ± 4 г



Масса пачки (50±4) г при влажности ваты 8%.
Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения 5(0Ж4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.
Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства/Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф. 8 (812) 252-56-11, 786-45-94
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Партия:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1
Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Противопоказаний к применению не имеет.
Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.
Не использовать вату, если упаковка повреждена.
Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.
Использовать только для наружного применения.
Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.
Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»
Н.А.Слободянюк
«01» ноября 2024г



Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 100г, зиг-заг

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг

100 г

± 5 г



Масса пачки (100±5) г при влажности ваты 8%.
Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения (ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности).
Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3.694-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовыми мусорами.



Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства / Организация, принимающая претензии: АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н. Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Пер. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Партия:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1
Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.
Противопоказаний к применению не имеет.
Меры предосторожности: использовать в составе перевязочного средства только ватные тампоны.
Не использовать вату, если упаковка повреждена.
Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.
Использовать только для наружного применения.
Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.
Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



«01» ноября 2024г



Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 200г, зиг-заг

BATA

**медицинская
гигроскопическая
хирургическая**

нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг



Масса пыли [2003] 10 г при влажности ваты 8%. Ухраняют в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения (50х6х) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности. Утилизацию: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-71. Упаковка, заделка с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовыми мусорами.

200 Г ± 10 г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»).

Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.

Место производства/Организация принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.

Тел./ф.: (812)252-56-11, 786-45-94

E-mail: mail@fabrika-nika.ru

www.fabrika-nika.ru

Пер. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Партия:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1
Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного

меры предосторожности: использовать в составе первичного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.
Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.
Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать только для наружного применения.

Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

«01» ноября 2024г



Этикетка на вату

медицинскую гигроскопическую хирургическую нестерильную
по ТУ 9393-004-31039208-2012, 250г, зиг-заг


Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг



Масса пачки (250±10) г при влажности ваты 8%.
Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте в соответствии с условиями хранения (ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности).
Утилизация: использованная вата утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Упаковка, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, утилизируются с бытовым мусором.

250 Г ±10 г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»).

Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.

Место производства/Организация принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.

Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94

E-mail: mail@fabrika-nika.ru

www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Партия:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 Таблица 1

Назначение: использовать в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.

Не использовать вату, если упаковка повреждена.

Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: взять необходимое количество ваты и использовать по назначению.


Состав: Хлопок - не менее 30%, химические волокна - не более 70%



Директор АО "Фабрика "Ника"

Н.А. Слободянюк

ноября 2024г

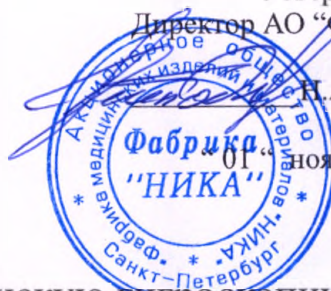

АО "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника"
190020, г.Санкт-Петербург, ул.Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Адрес производства:190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н* тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E - m a i l : m a i l @ f a b r i k a - n i k a . r u



BATA

МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ **ХИРУРГИЧЕСКАЯ**

НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ТУ 9393-004-31039208-2012

Масса нетто(влажность 8%)

20 кг ±0,2 кг

Масса брутто

20,3 кг ±0,2 кг



Номер партии

Дата изготовления


Рег.уд.№РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Срок годности 6 лет

Состав:

хлопок - не менее 30%

химические волокна - не более 70%



“Утверждаю”
Директор АО “Фабрика “Ника”
И.А. Слободянюк
01 ноября 2024г



Макет этикетки на вату медицинскую гигроскопическую
хирургическую нестерильную по ТУ 9393-004-31039208-2012,
30кг, кипа



АО “Фабрика медицинских изделий и материалов “Ника”
190020, г.Санкт-Петербург, ул.Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Адрес производства:190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н* тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E - m a i l : m a i l @ f a b r i k a - n i k a . r u

ВАТА

МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ТУ 9393-004-31039208-2012

Масса нетто (влажность 8%)

30кг ±0,3 кг

Масса брутто

30,3 кг ±0,3 кг



Номер партии

Дата изготовления


Рег.уд.№РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Срок годности 6 лет

Состав:

хлопок - не менее 30%

химические волокна - не более 70%



“Утверждаю”

Директор АО “Фабрика “Ника”

Н.А. Слободянюк

01 ноября 2024г



Макет этикетки на вату медицинскую гигроскопическую
хирургическую нестерильную по ТУ 9393-004-31039208-2012,
40кг, кипа



АО “Фабрика медицинских изделий и материалов “Ника”
190020, г.Санкт-Петербург, ул.Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Адрес производства:190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н* тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E - m a i l : m a i l @ f a b r i k a - n i k a . r u

БАТА

МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ **ХИРУРГИЧЕСКАЯ**
НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ТУ 9393-004-31039208-2012

Масса нетто (влажность 8%)

Масса брутто

40кг ±0,4 кг

40,4 кг ±0,4 кг



Номер партии

Дата изготовления


Рег.уд.№РЗН 2013/229 от 26.06.2019г


Срок годности 6 лет

Состав:

хлопок - не менее 30%

химические волокна - не более 70%



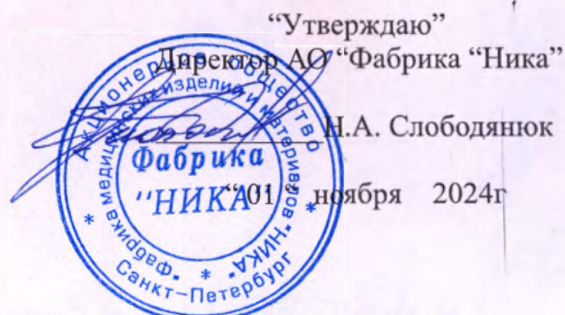

Макет этикетки на вату медицинскую гигроскопическую
хирургическую нестерильную по ТУ 9393-004-31039208-2012,
50кг, кипа



АО “Фабрика медицинских изделий и материалов “Ника”
190020, г.Санкт-Петербург, ул.Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Адрес производства:190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н* тел.: (812) 786-45-94, тел./ф.: (812) 252-56-11
E - m a i l : m a i l @ f a b r i k a - n i k a . r u

ВАТА

МЕДИЦИНСКАЯ ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ по ТУ 9393-004-31039208-2012

Масса нетто (влажность 8%)

50кг ±0,5 кг

Масса брутто

50,4 кг ±0,5 кг



Номер партии

Дата изготовления

Рег.уд.№РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Срок годности 6 лет

Состав:

хлопок - не менее 30%

химические волокна - не более 70%



Прошито, пронумеровано и заверено
печатью

18 (восемнадцать) листов
Директор АО «Фабрика «Ника»

С.А. Виноков Н.А.



«Утверждаю»

Директор АО «Фабрика «Ника»

Н.А.Слободянюк

2024г



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Вата медицинская гигроскопическая хирургическая

нестерильная» по ТУ 9393-004-31039208-2012

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

в рулонах массой по $(25 \pm 2)г$; $(50 \pm 4)г$; $(100 \pm 5)г$; $(200 \pm 10)г$; $(250 \pm 10)г$; $(500 \pm 20)г$; $(1000 \pm 40)г$; $(2500 \pm 100)г$.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по $(25 \pm 2)г$



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (50±4)г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифшицкая, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Факс: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru
АО «Фабрика «Ника» имеет сертификат, подтверждающий претензии:
Ул. Лифшицкая, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Рег. Уд. № РЗН 2013/228
от 28.06.2019 г.

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

50 ± 4 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (100±5)г

Исполнитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий»
и малолетних «Ника» (АО «Фабрика «Ника»»
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д. 3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д. 3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-55-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru



Рег. Уд. № РЗН 2013/229
от 26.06.2019 г.



вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

100

±5 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий
транспортировки и хранения.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная


по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (200±10)г



Изготовитель: Акционерное общество "Фабрика медицинских изделий и материалов "Ника" (АО "Фабрика "Ника")
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифинская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства / Организация, принимающая претензии:
АО "Фабрика "Ника", Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифинская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8(812)252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

ВАТА МЕДИЦИНСКАЯ
ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ 200^{±10}₂

РЕГУД. № РЗН 2013/229 от 26.06.2019 г.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (250±10)г



использовать по назначению.

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника»,
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая


250 ± 10 г

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Пер. Уд. № РЗН 2013/229
от 26.06.2019 г.

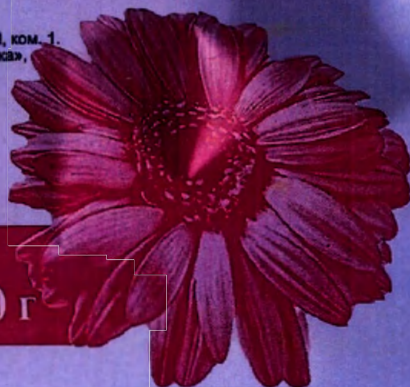

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (500±20)г

а) в бумаге





Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит. А, пом. 5-Н, ком. 1.
Место производства / Организация, принимающая претензии: АО «Фабрика «Ника»,
Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел./ф.: 8 (812) 252-56-11, 786-45-94, e-mail: mail@fabrika-nika.ru

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

500 ± 20 г

нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

Срок годности 6 лет с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Рег. Уд. № РЗН 2013/229
от 26.06.2019 г.

6) в пленке

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (1000±50)г



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5Н, ком.1.
Место производства: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н, тел. 8(812)786-45-94, 8(812)252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

БАТА (1000 ± 50) г
медицинская гигроскопическая
хирургическая **НЕСТЕРИЛЬНАЯ**
по ТУ 9393-004-31039208-2012

Дата изготовления _____ Партия _____

Предназначена для использования в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Состав
волокно хлопковое - не менее 30%
волокно химическое - не более 70%

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства однократного применения.
Не использовать, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.
Использовать только для хирургического применения.

Способ применения: Вуль необходимое количество ваты и использовать по назначению.

Хранить в складских помещениях на стелжах в запыленном от атмосферных осадков месте.

в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизировать использованную вату по СанПиН 2.1.3684-21. Упаковку, изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид утилизировать с бытовыми отходами.

Срок годности 6 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.

РУ №РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 таблица 1



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в рулонах массой по (2500±100)г



Изготовитель: АО "Фабрика "Ника"
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5Н, ком.1.
Место производства: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д.3,
лит. В, пом. 23-Н, 21-Н, тел. 8(812)786-45-04, 8(812)252-56-11
E-mail: mail@fabrika-nika.ru

ВАТА (2500 ± 100)г
медицинская гигроскопическая
хирургическая **НЕСТЕРИЛЬНАЯ**
по ТУ 9393-004-31039208-2012

Дата изготовления _____ Партия _____

Предназначена для использования в качестве сорбционного материала в составе перевязочных средств.

Состав
волокно хлопковое - не менее 30%
волокно химическое - не более 70%

Противопоказаний к применению не имеет.

Меры предосторожности: Использовать в составе перевязочного средства одноразового применения.

Не использовать, если упаковка повреждена. Не использовать по истечению указанного на упаковке срока годности.

Использовать только для наружного применения.

Способ применения: Впитать необходимое количество влаги и использовать по назначению.

Хранить в складских помещениях на стеллажах в защищенном от атмосферных осадков месте.

в соответствии с условиями хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150 и правилами пожарной безопасности.

Утилизировать использованную вату по СанПиН 2.1.3.684-21. Упаковку, и целую с истекшим сроком

годности или утратившую товарный вид утилизировать с бытовыми отходами.

Срок годности 6 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения.

РУ №РЗН 2013/229 от 26.06.2019г

Вата соответствует требованиям ГОСТ 5556 табл.1



ЗИГ-ЗАГ массой по $(50 \pm 4)г$; $(100 \pm 5)г$; $(200 \pm 10)г$; $(250 \pm 10)г$.

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 зиг-заг массой по $(50 \pm 4)г$



Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012

ЗИГ-ЗАГ

50 Г $\pm$ 4 г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства/Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел. 8(812) 252-56-11, 786-45-94
E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Номер партии:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 зиг-заг массой по (100±5)г

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая
нестерильная
по ТУ 9393-004-31039208-2012



зиг-заг



100 г
± 5 г

Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства/Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел. 8(812) 252-56-11, 786-45-94
E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:
Номер партии:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 зиг-заг массой по (200±10)г

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг

200 г ±10 г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)
Юр. Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.
Место производства/Организация, принимающая претензии:
АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит. 8, пом. 23-Н, 21-Н.
Тел. 8(812) 252-56-11, 786-45-94
E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:
Номер партии:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 зиг-заг массой по (250±10)г

Вата

медицинская
гигроскопическая
хирургическая

нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012



Зиг-заг

250 Г ±10 г



Изготовитель: Акционерное общество «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника» (АО «Фабрика «Ника»)

Юр. Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,
Ул. Лифляндская, д.3, лит.А, пом. 5-Н, ком.1.

Место производства/Организация, принимающая претензии:

АО «Фабрика «Ника», Россия, 190020, г. Санкт-Петербург,

Ул. Лифляндская, д.3, лит. В, пом. 23-Н, 21-Н.

Тел. 8(812) 252-56-11, 786-45-94

E-mail: mail@fabrika-nika.ru www.fabrika-nika.ru

Рег. уд. № РЗН 2013/229 от 26 июня 2019г

Дата изготовления:

Номер партии:

Срок годности 6 лет с даты изготовления при
соблюдении условий хранения и транспортирования




та медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная по ТУ 9393-004-31039208-2012

в кипах массой по $(20 \pm 0,2)$ кг; $(30 \pm 0,3)$ кг; $(40 \pm 0,4)$ кг; $(50 \pm 0,5)$ кг.


Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в кипах массой по $(20 \pm 0,2)$ кг

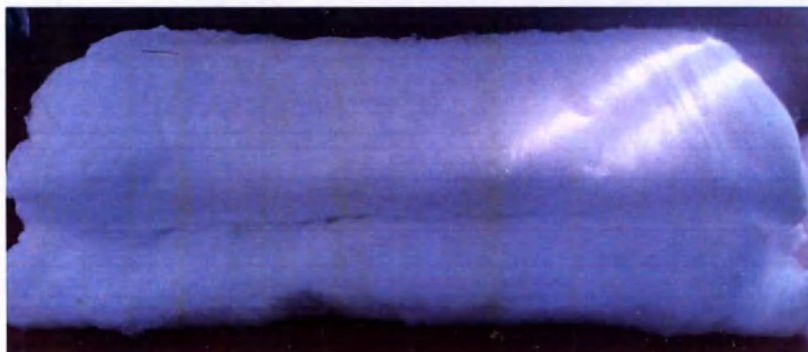


Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в кипах массой по $(30 \pm 0,3) \text{ кг}$

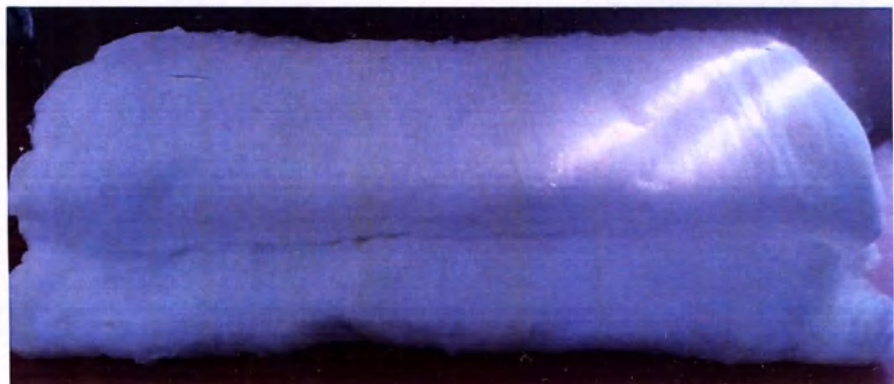

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в кипах массой по $(40 \pm 0,4)$ кг

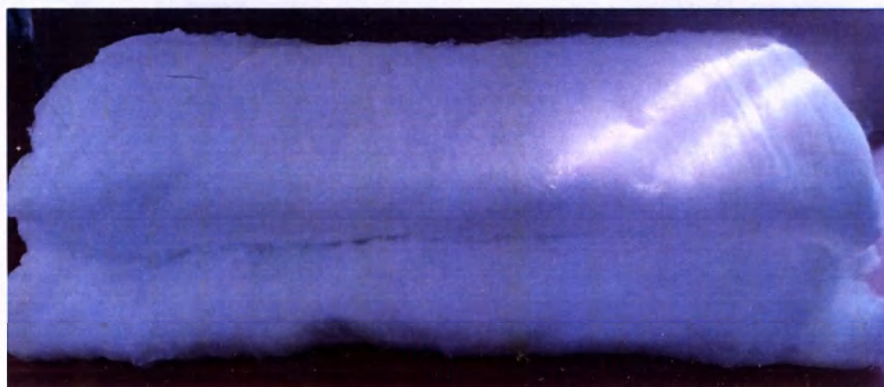

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная

по ТУ 9393-004-31039208-2012 в кипах массой по (50±0,5)кг



Прошито, пронумеровано и заверено
печатью

18 (восемнадцать) листов _

Директор АО «Фабрика «Ника»

