

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РесортМед»


Мамедов Д. Ю.

2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Аппарат физиотерапевтический для диатермии «RSHOCK»
производства компании
ВИНБЭК ГОУ ИСТ Ко., Лтд (WINBACK GO EAST Co., Ltd), Корея**


Блок основной «RSHOCK» вид спереди

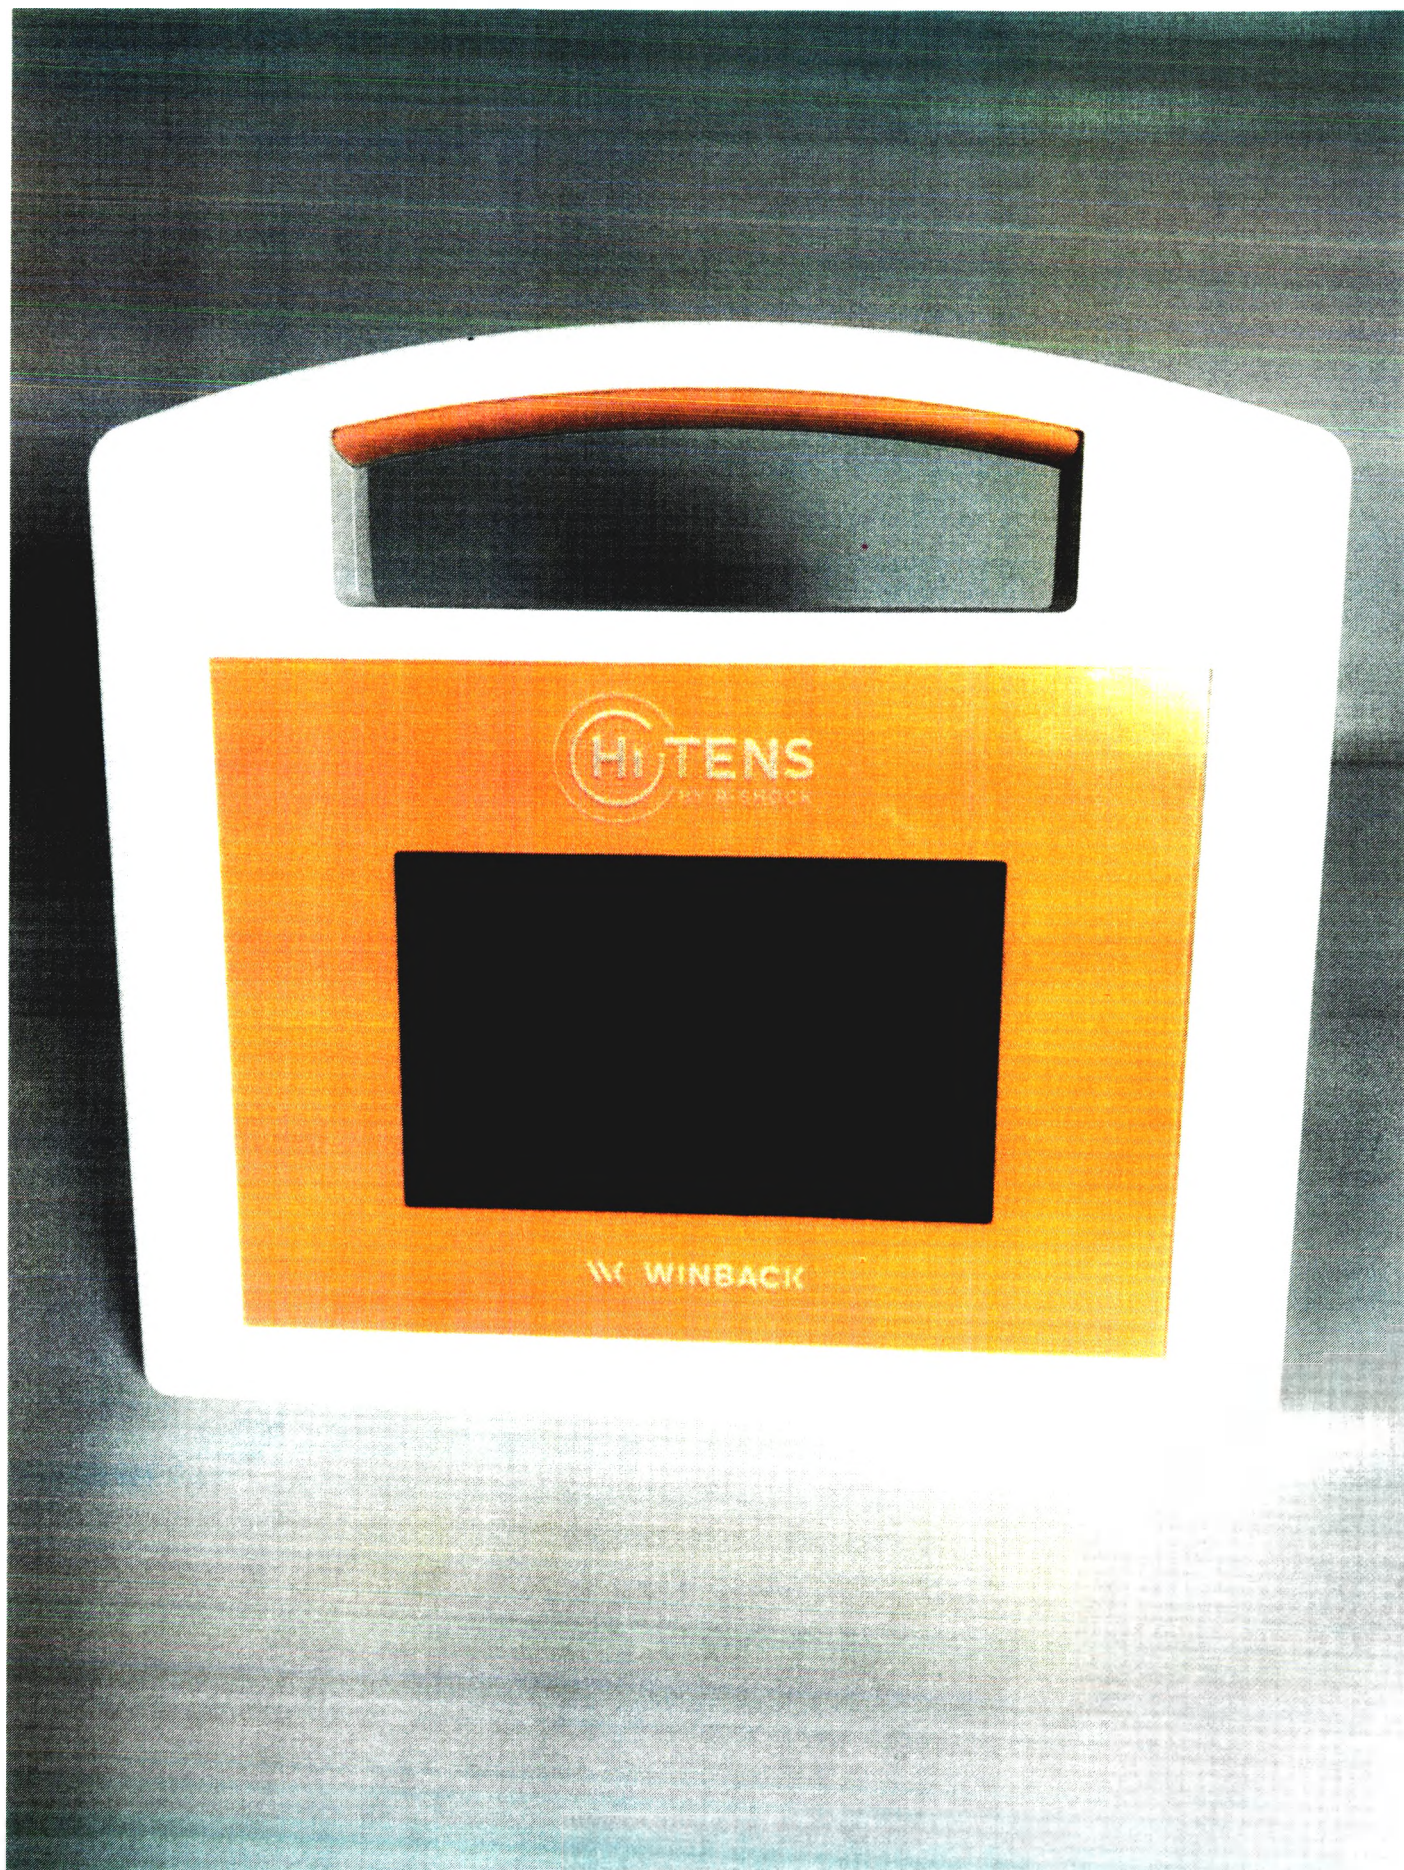

Блок основной «RSHOCK» вид слева

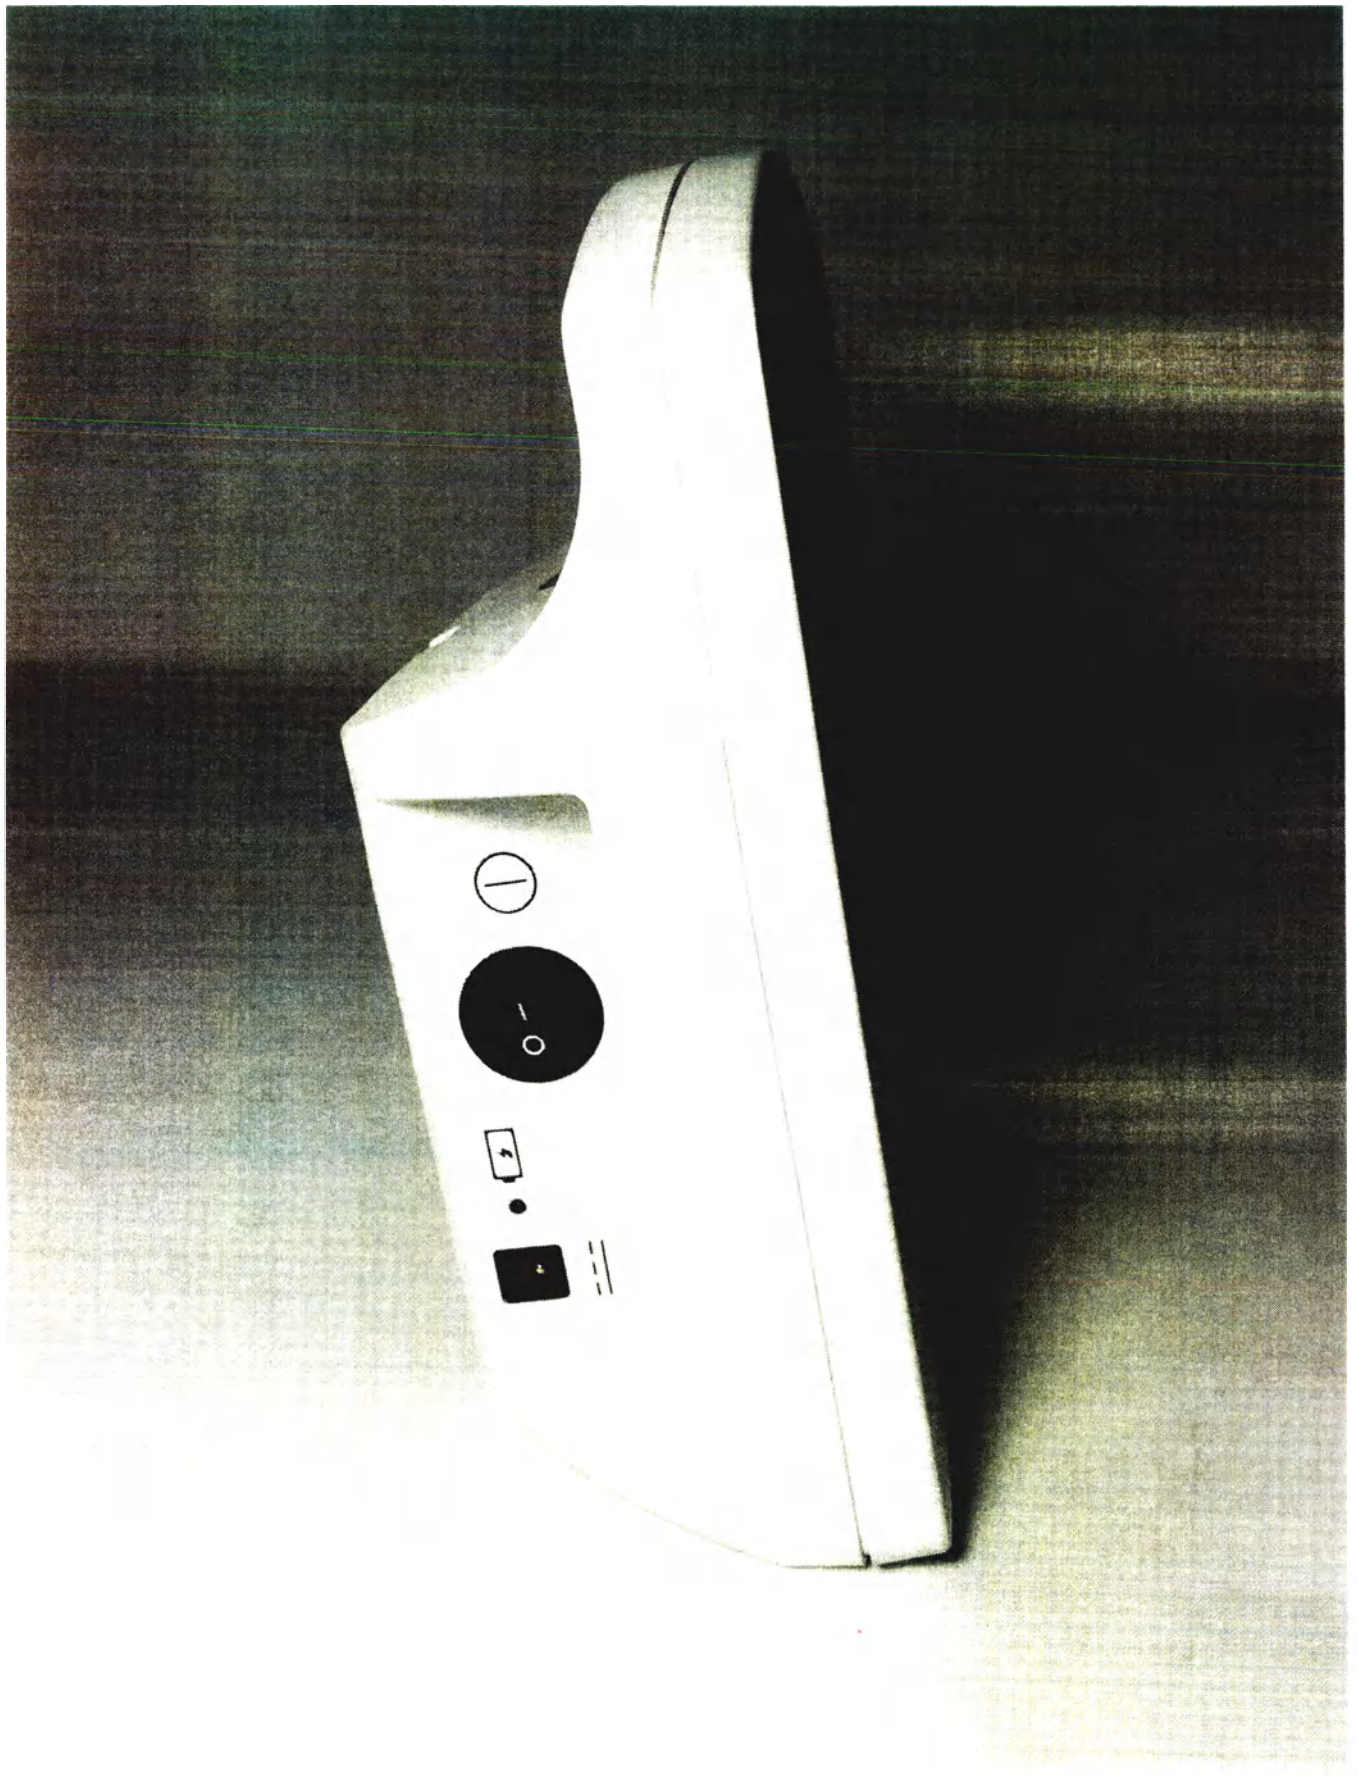

Блок основной «RSHOCK» вид справа

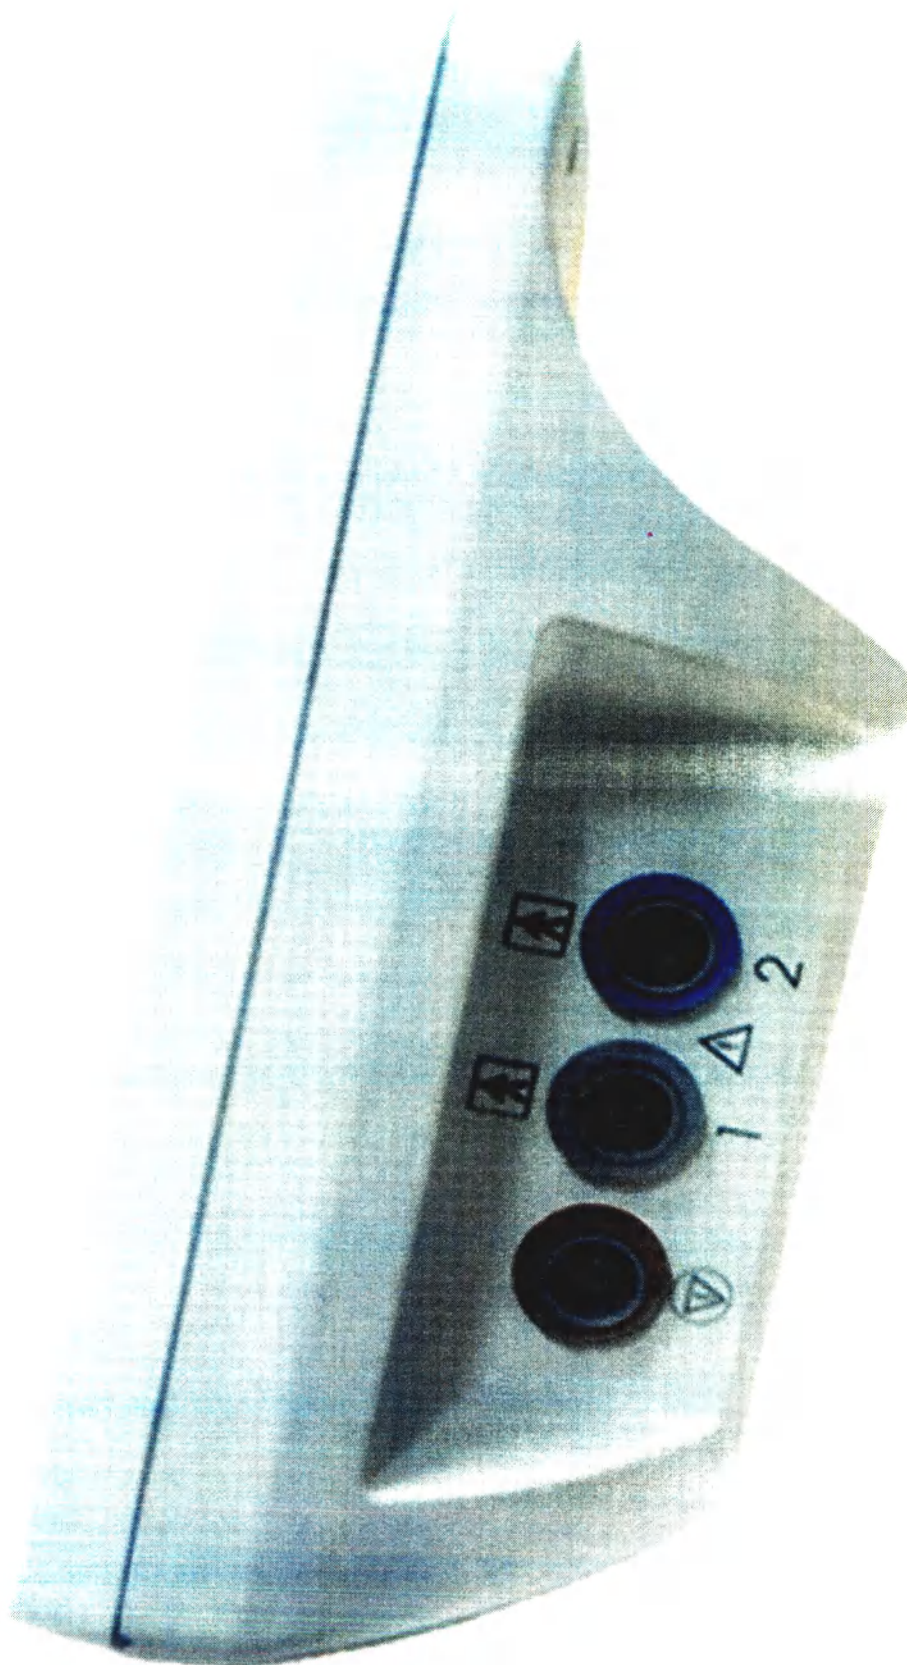

Блок основной «RSHOCK» вид сзади



T.E.C.A.R.
THERAPY
DEVICE

Model: RSHOCK
WG29AD2R322100191
13-10-2022


Power Supply: 100-240V, 50/60Hz Weight: 1.2 kg
Driving Power Consumption: 80 VA
Intensity delivered: 14.4 V d.c. 9.550mA
Intermittent use: Turn off the device 10 minutes
between each cycle exceeding 10 min
Measuring band: 1500-2400 beats
Power consumption: up to 2000W max.

WARNING: Read the instructions carefully before using the device.
For safety reasons, do not use the device for children.


CE

WG29AD2R322100191

Блок основной «RSHOCK» вид снизу

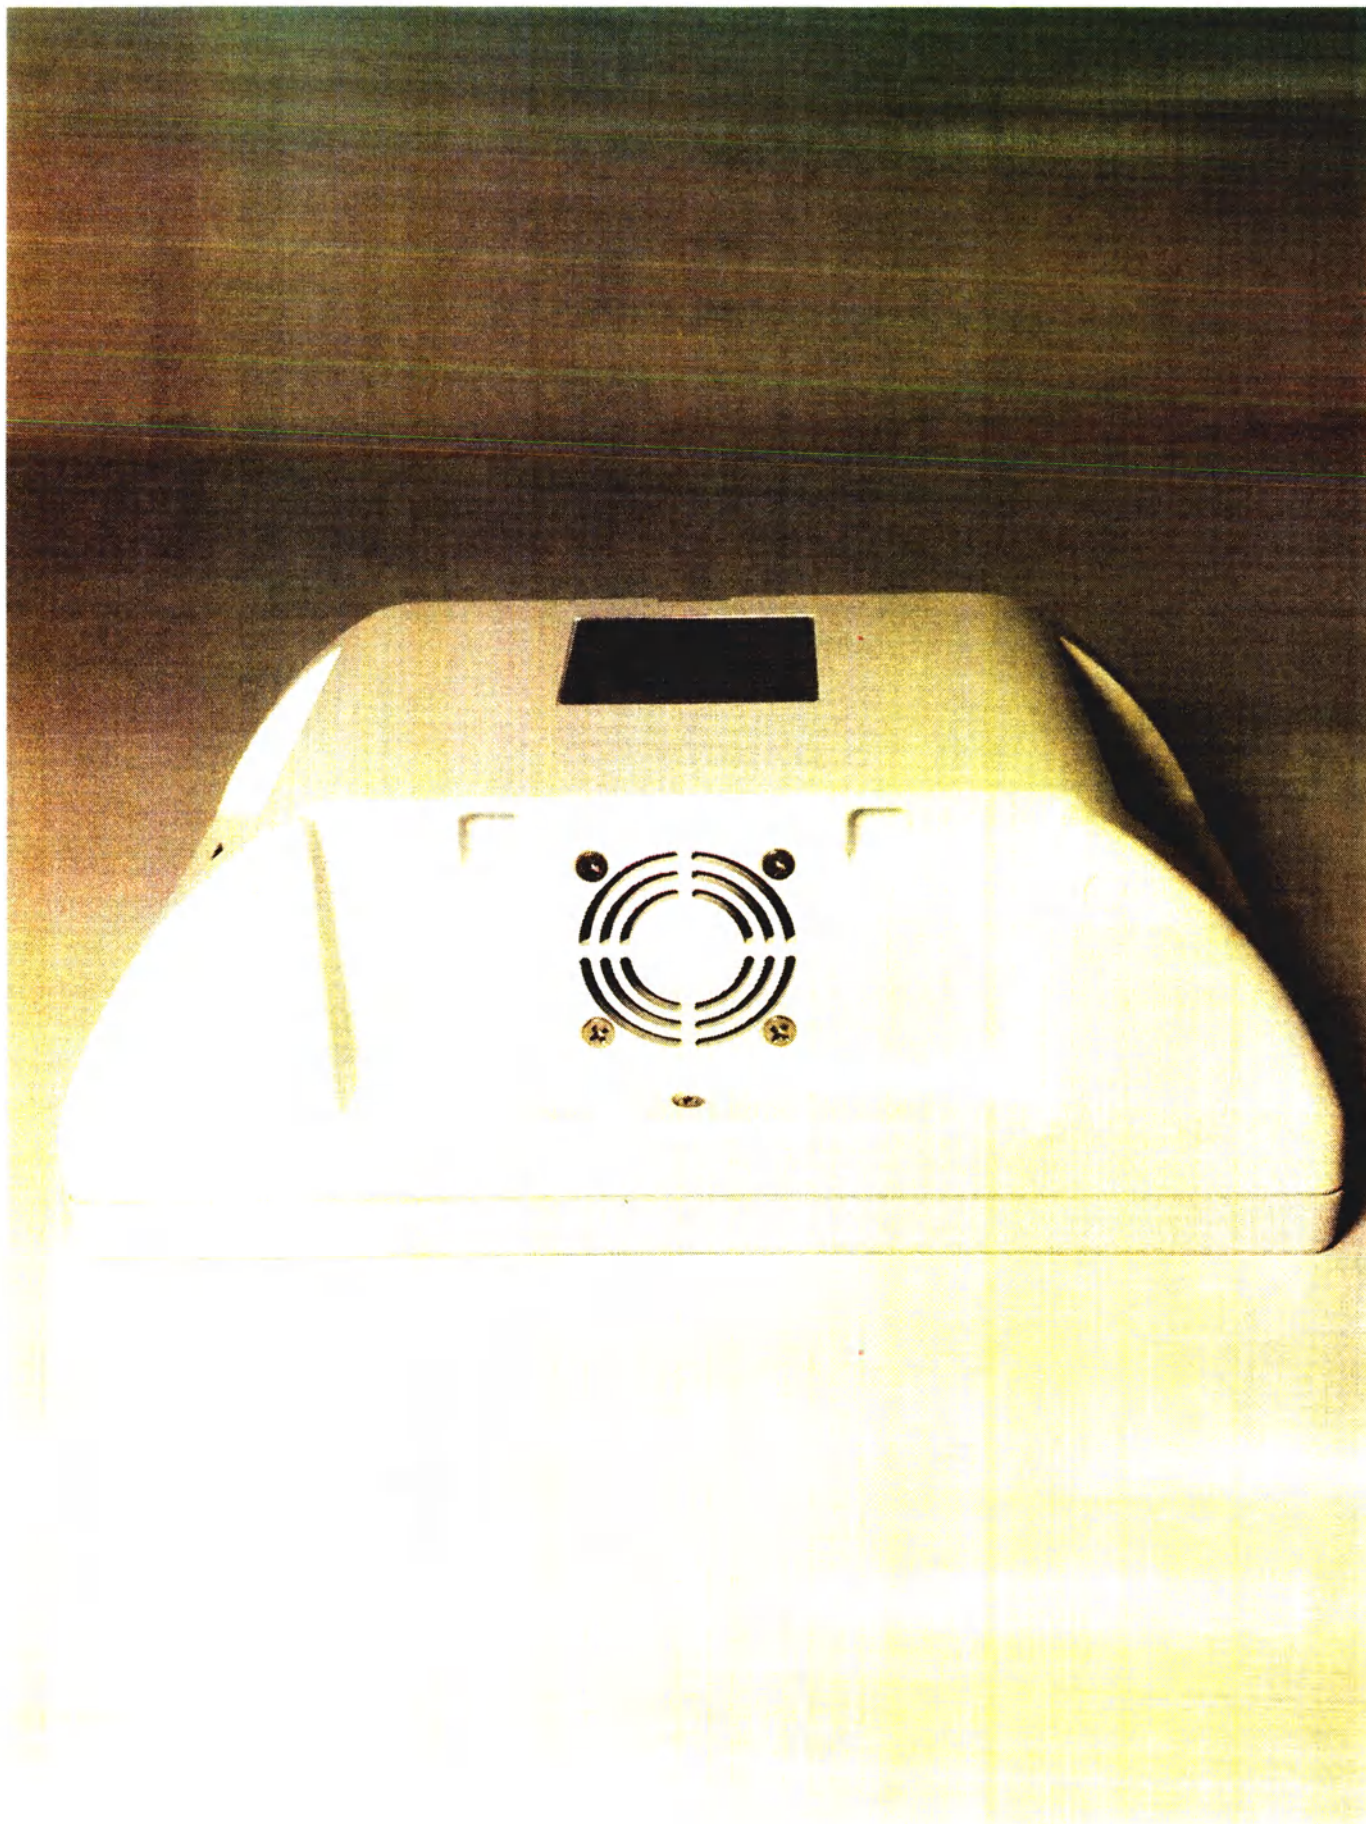

Ручка аппликатора Тесар 6.0 с кабелем (артикул: ACC.45) и аппликаторами T SHOCK 10*10 и T SHOCK 14*14

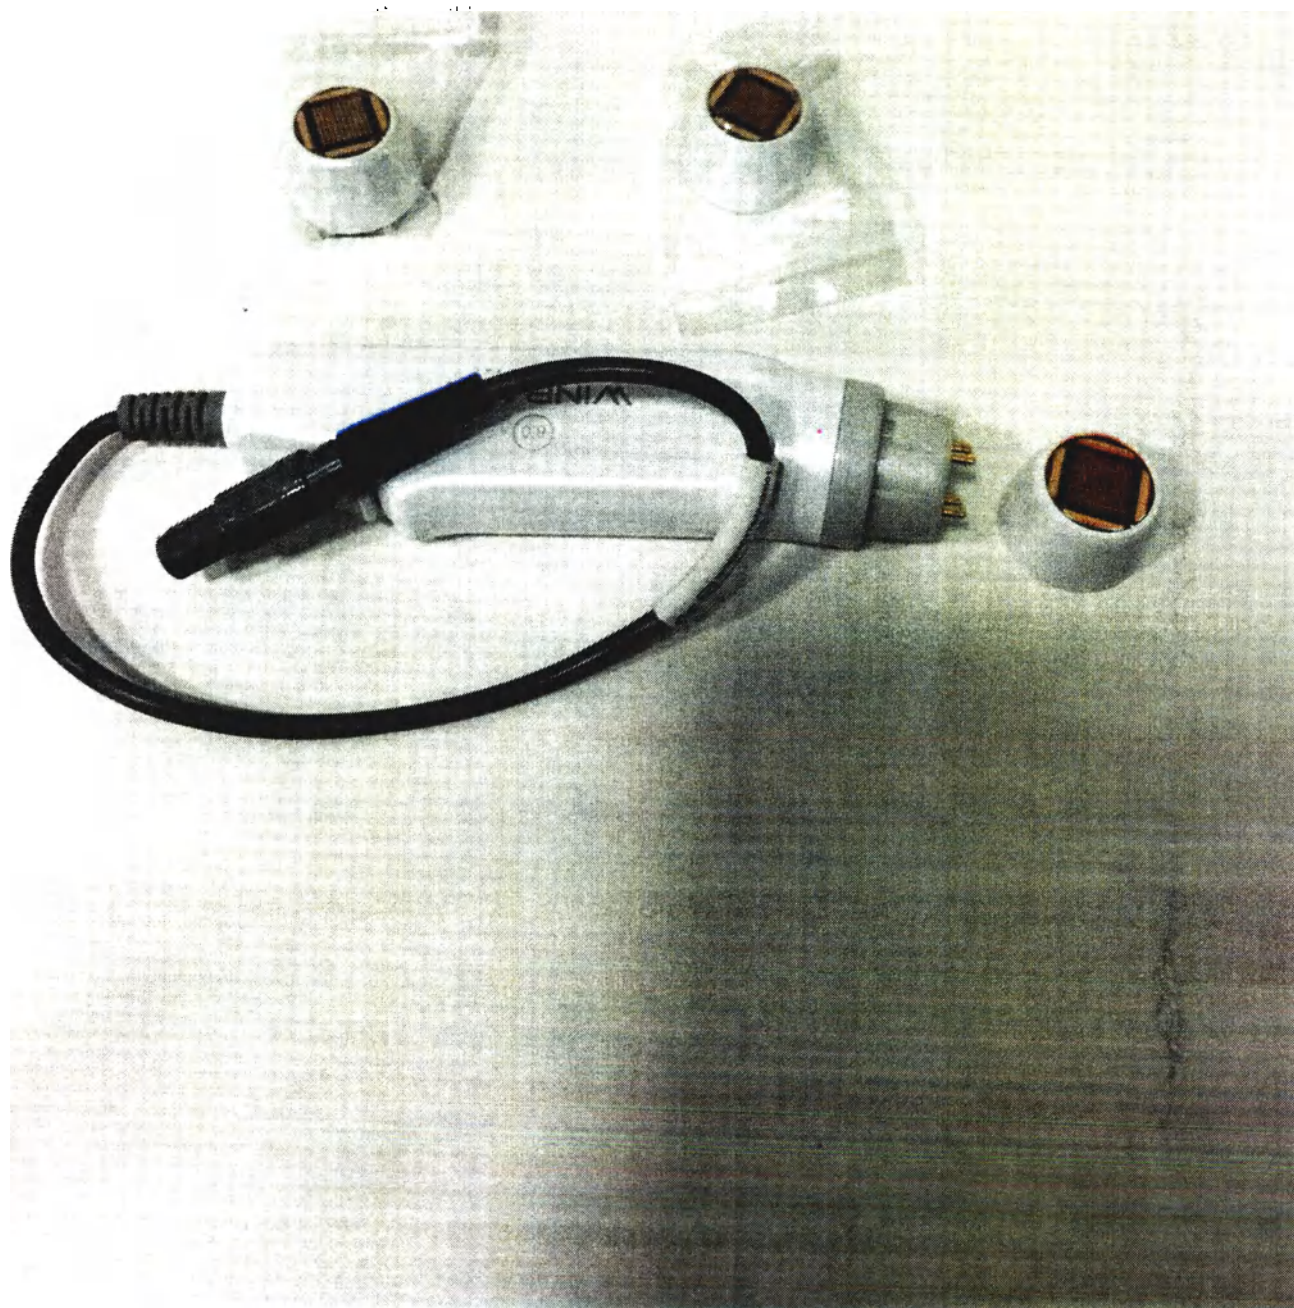


Аппликатор Т SHOCK 10*10



Аппликатор Т SHOCK 14*14




Пластина нейтральная с фиксатором (артикул: ACC.14)

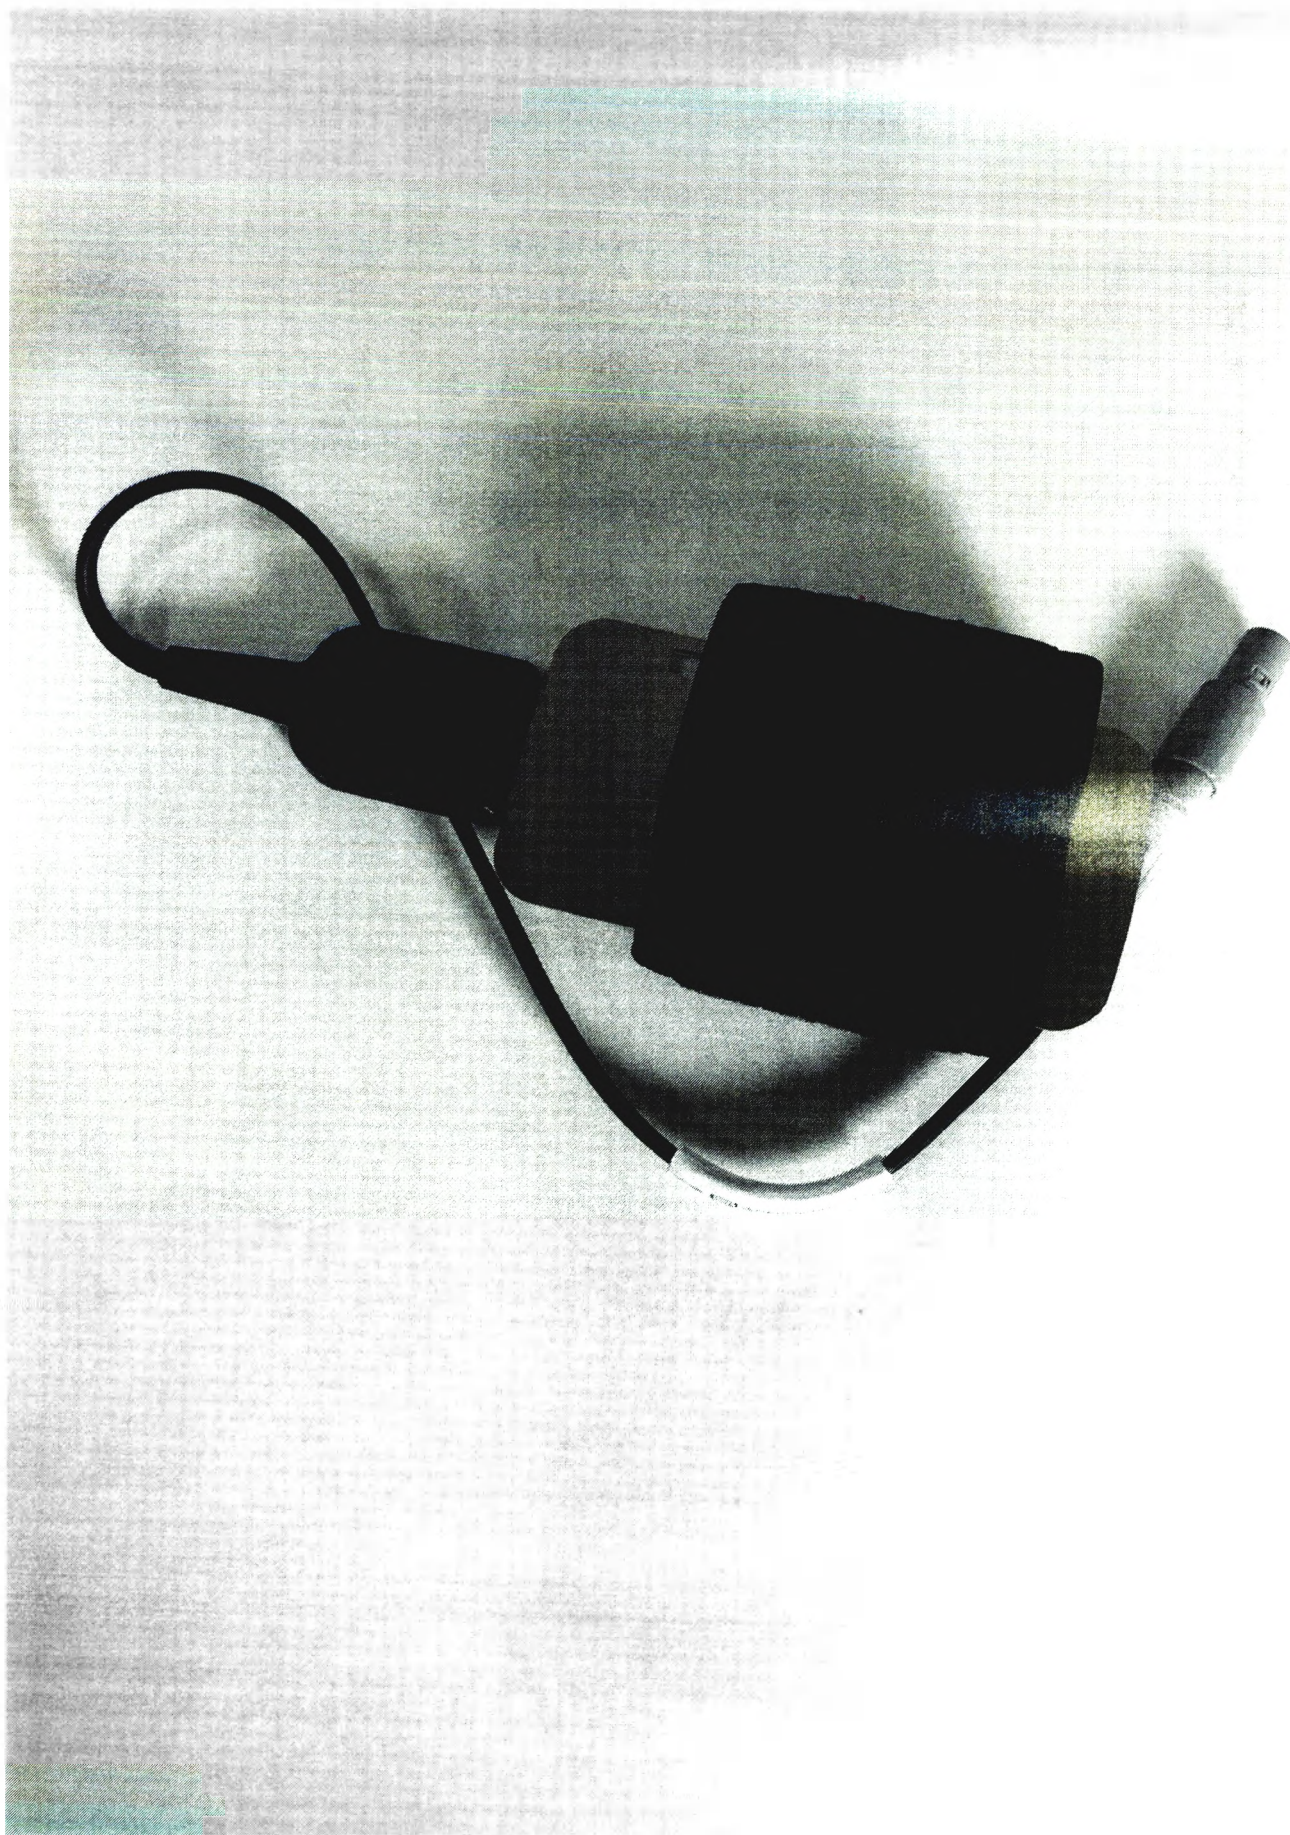

Ручка аппликатора резистивная Tescar 3.0 с кабелем (артикул: ACC.17)




Электрод резистивный RET Ø 60 мм - 1 шт.

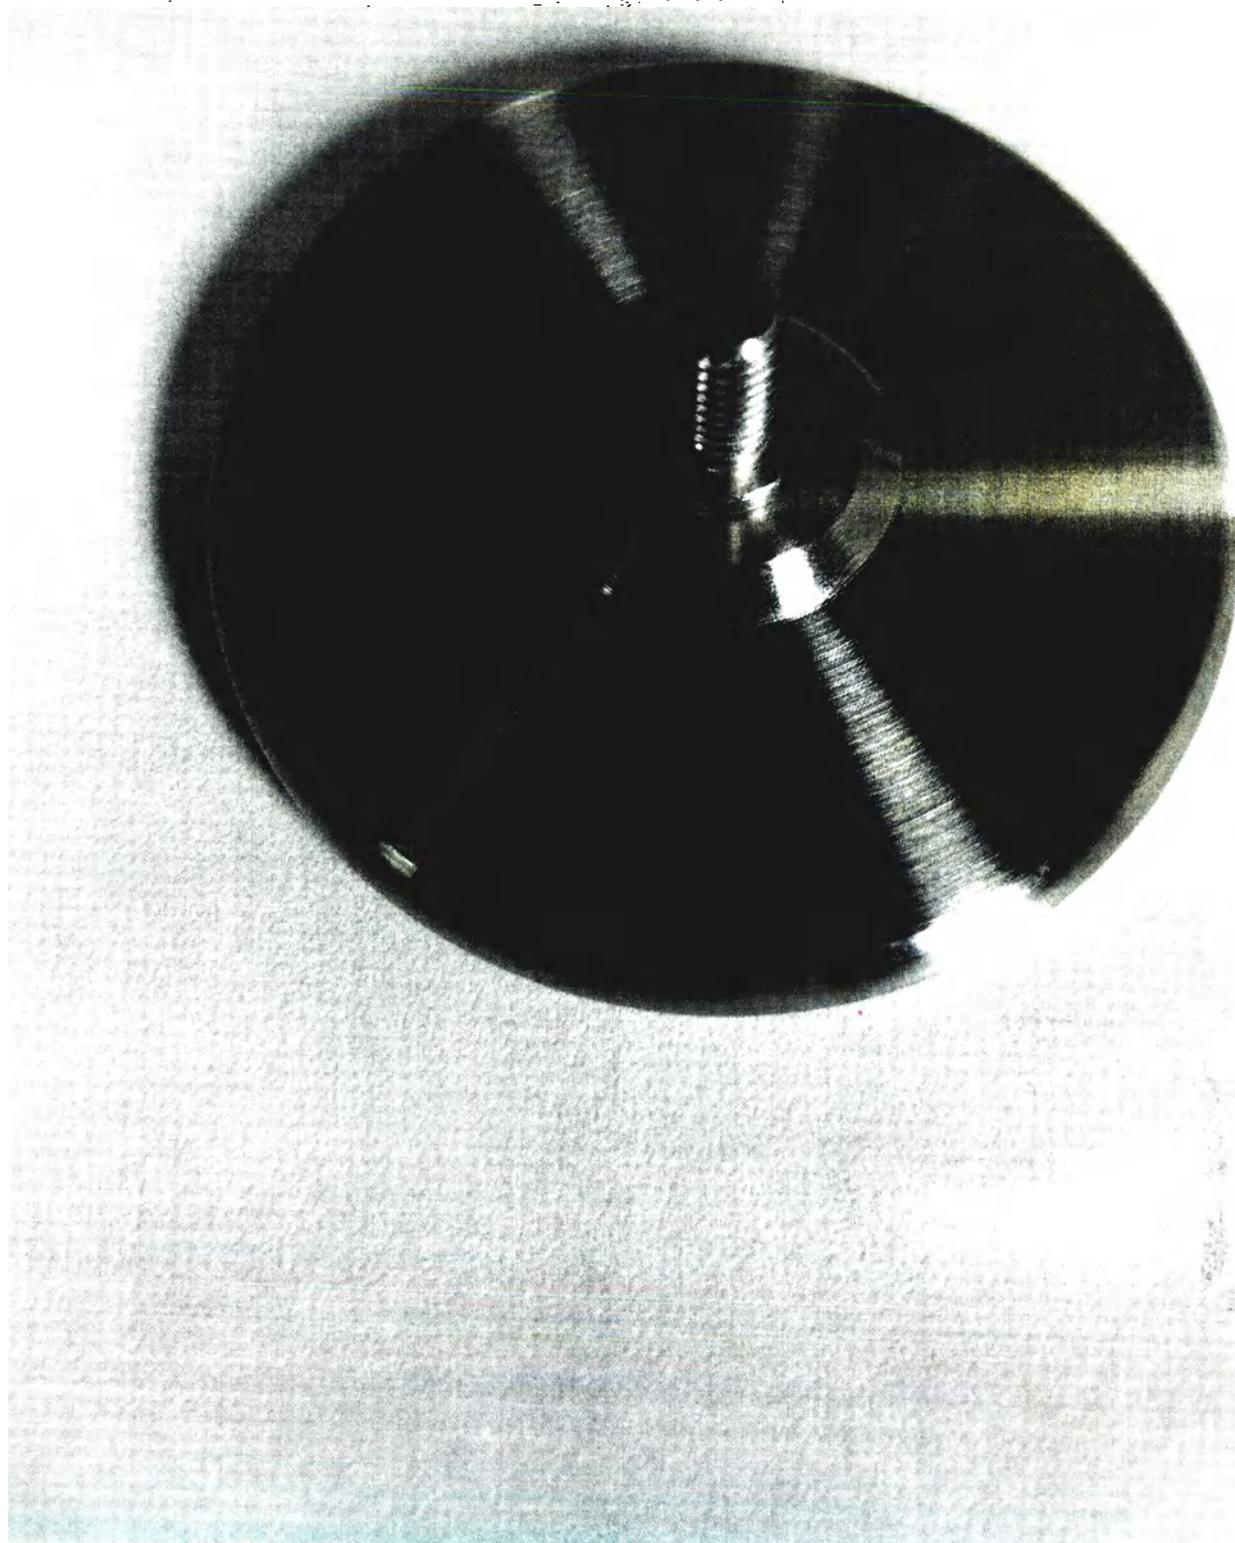

Электрод резистивный RET Ø 40 мм



Защитные кольца размера S и размера M

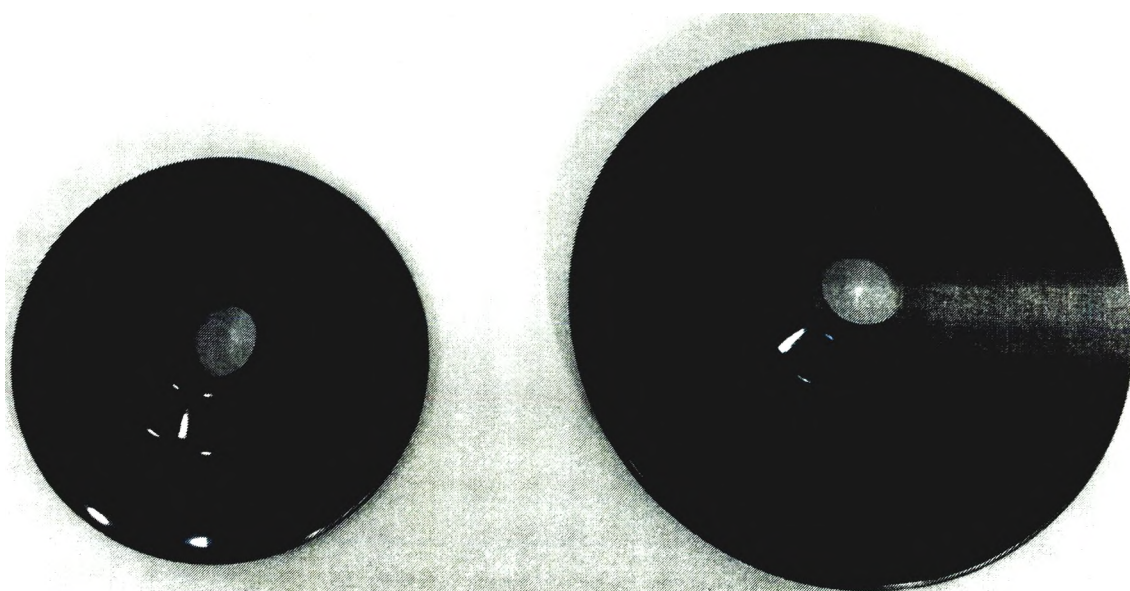


Кнопка аварийной остановки (артикул: ТЕК.8)



Кабель-удлинитель для нейтральных и резистивных аксессуаров (артикул: ACC.9)




Кабель-удлинитель для аппликатора Тесар 6.0 (артикул ACC.8)

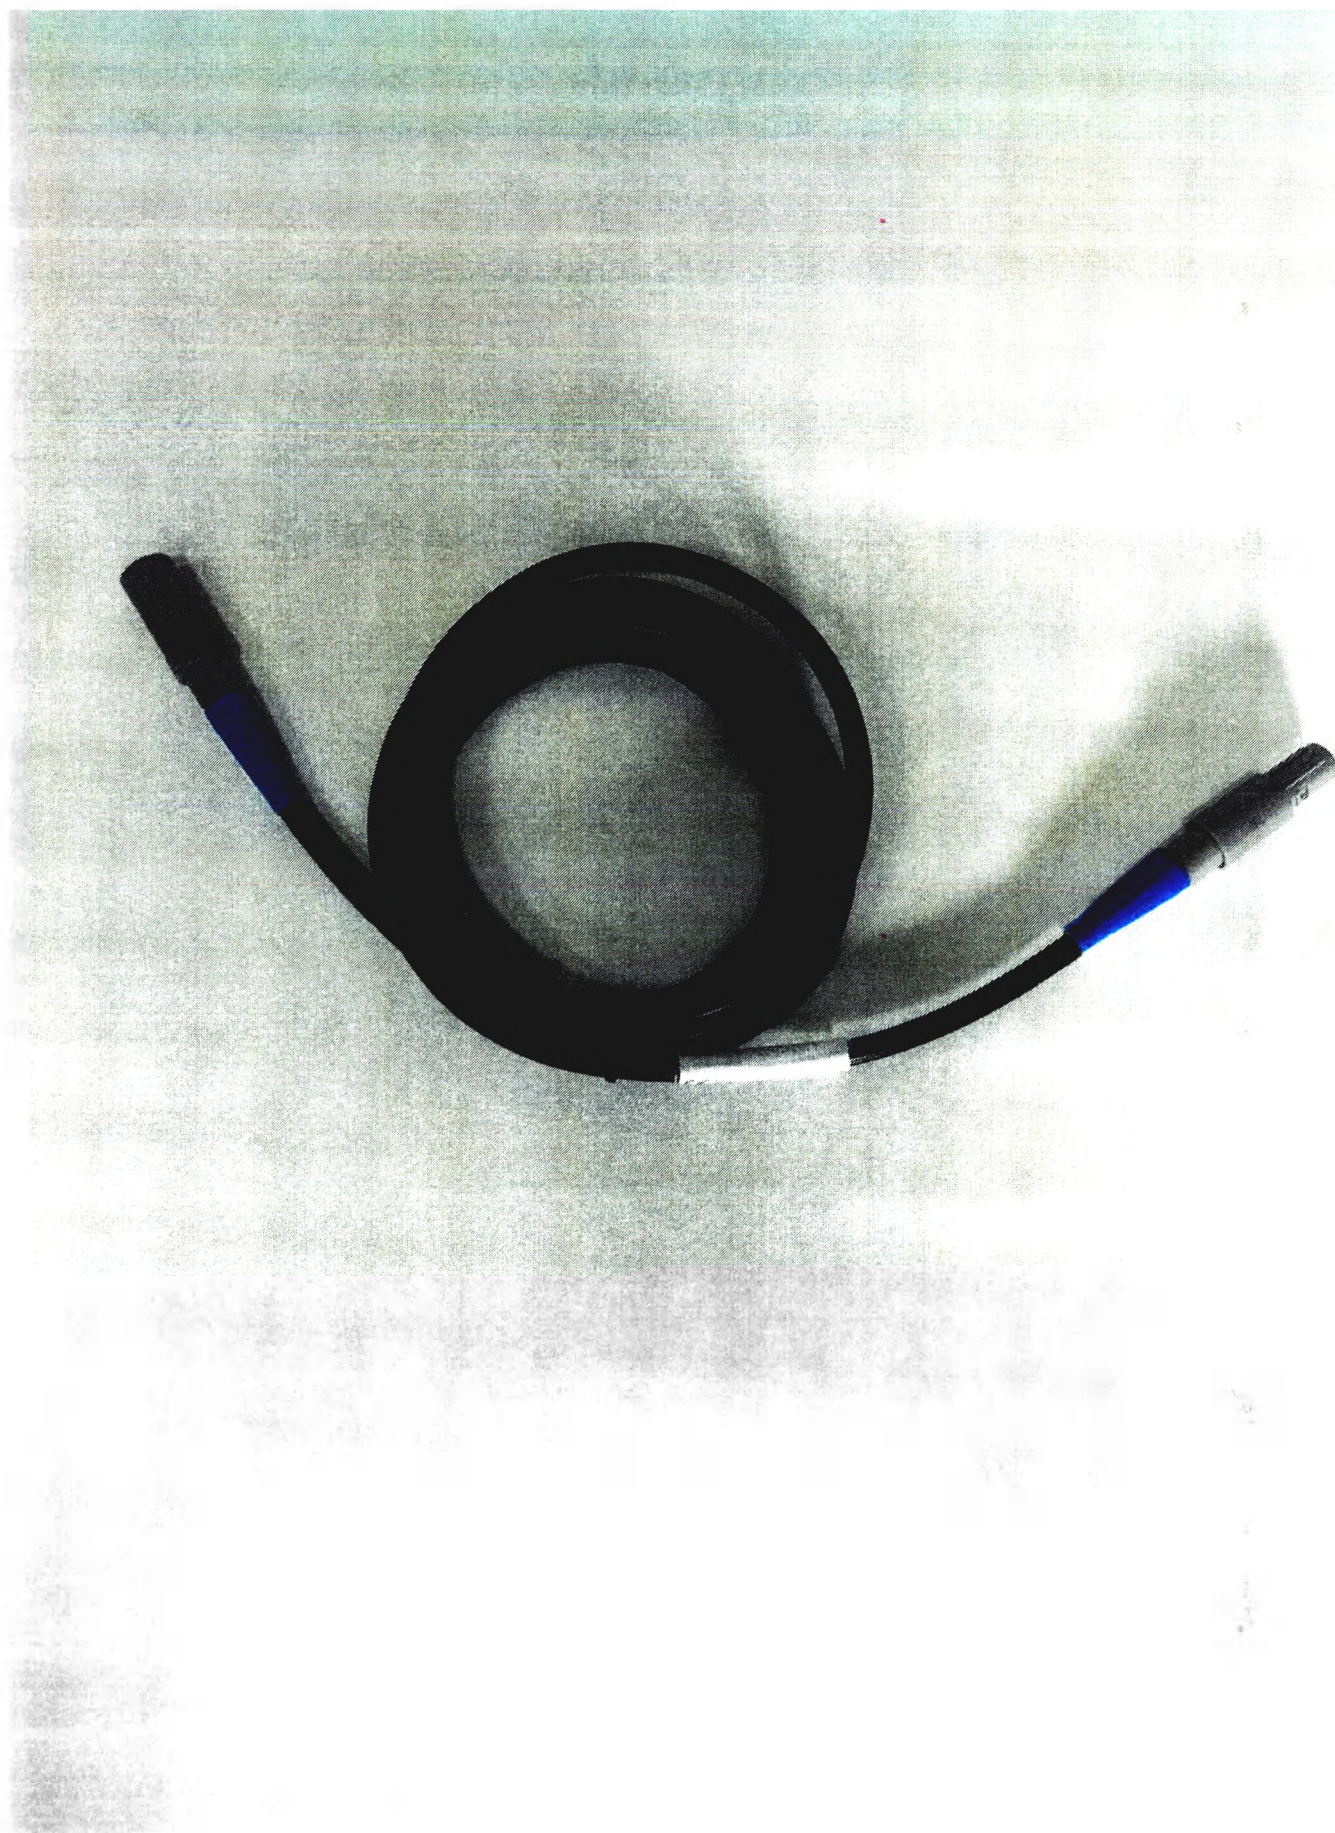

Блок питания для аккумулятора (артикул: GSMB90B12-P1M)



Шнур питания (адаптер) (артикул: H03VVH2-F)

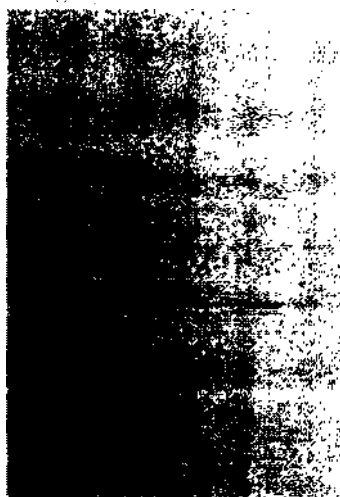

Проводящий крем




Сумка для транспортировки






Набор для фасции: Ручка аппликатора для фасции с кабелем

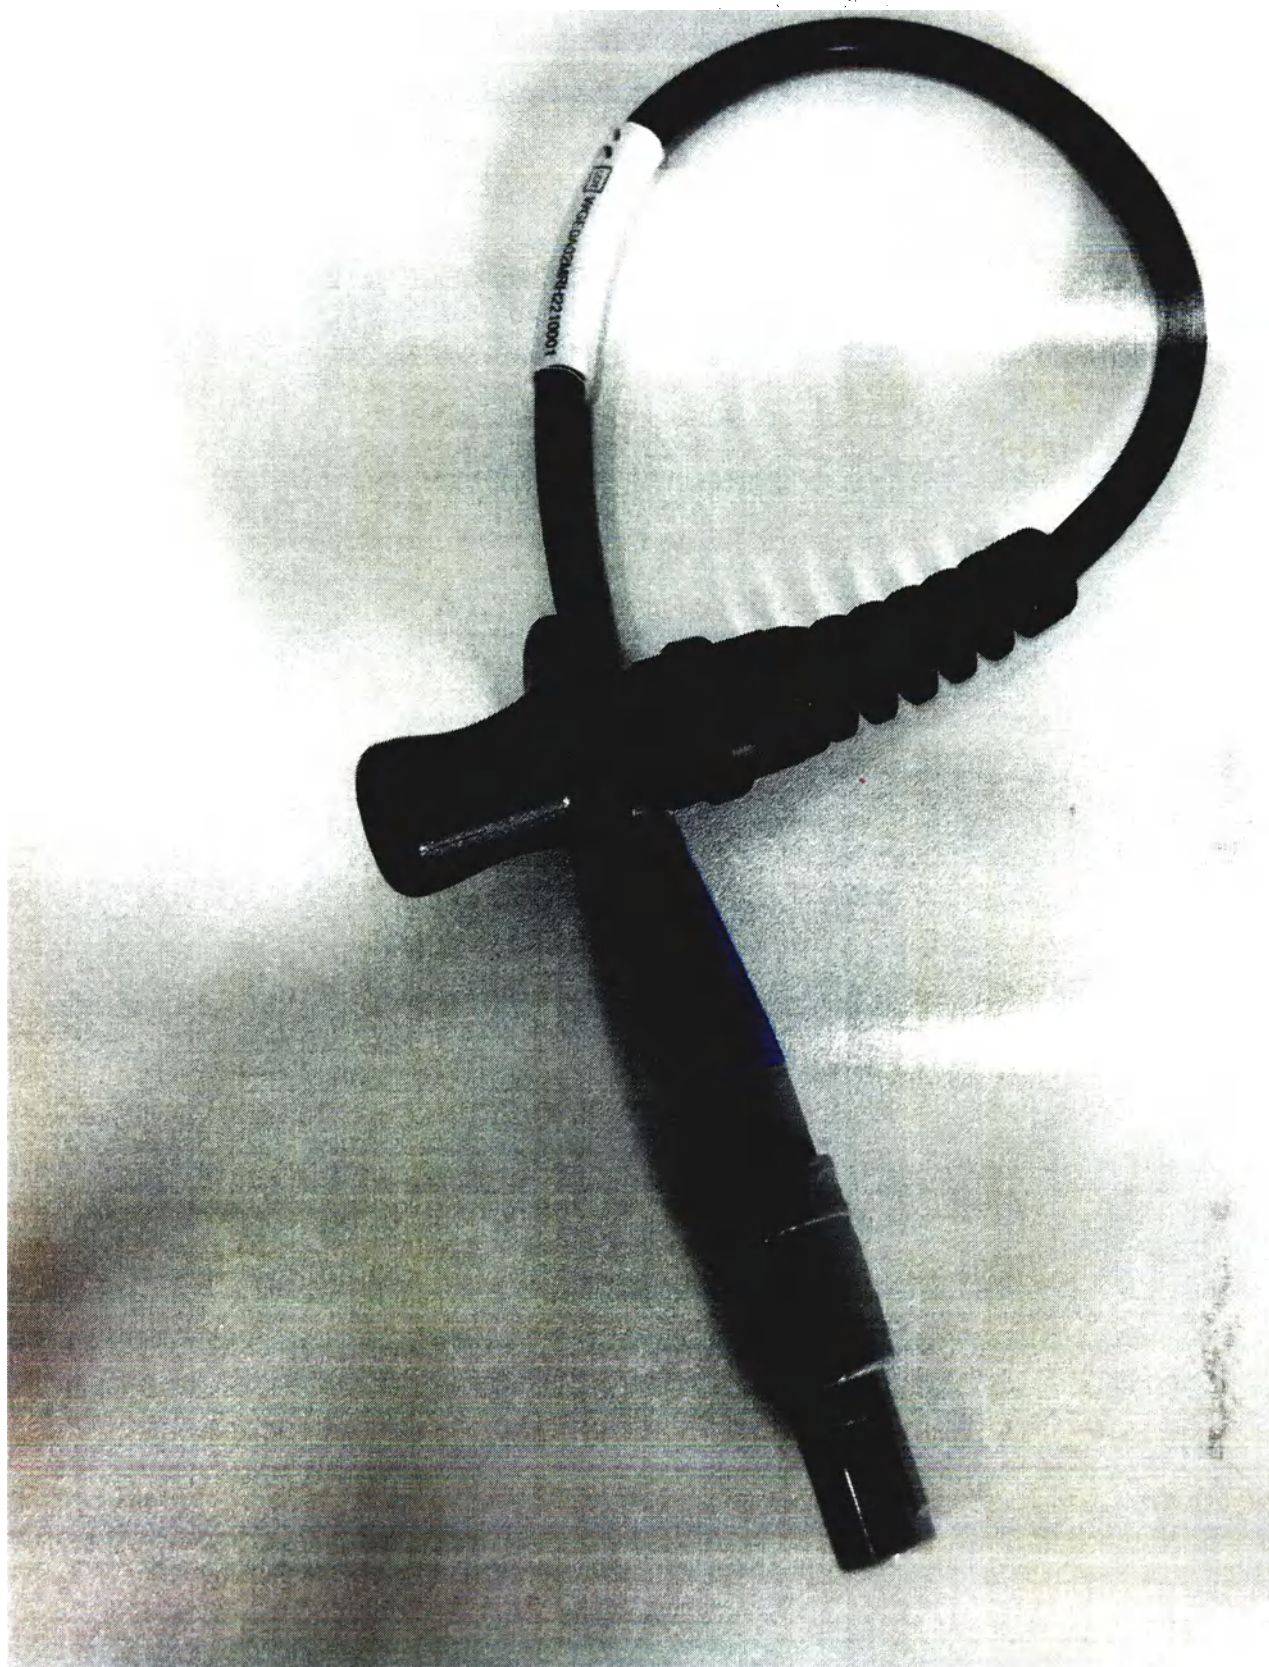


Набор для фасции: Инструмент для массажа фасции



Набор для фасции: Электрод резистивный RET выпуклый Ø 25 мм

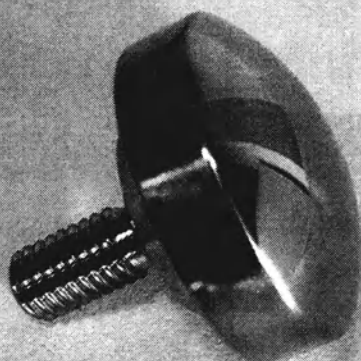

Набор для фасции: Чехол для набора фасции

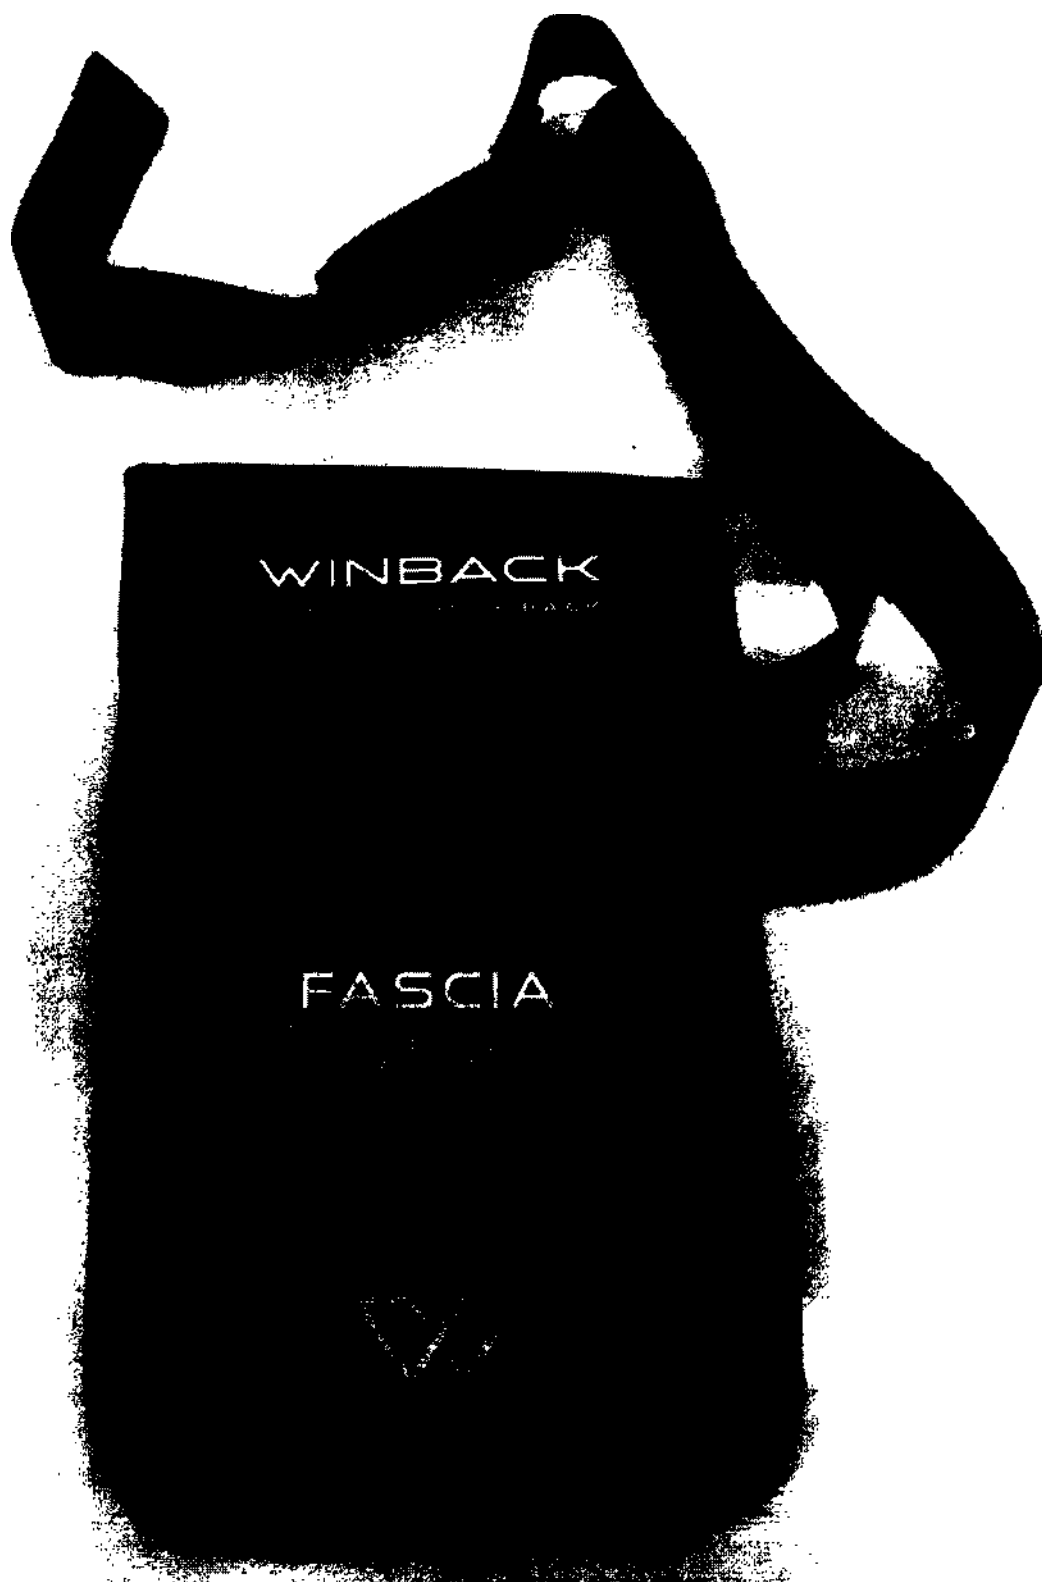



RU

WINBACK

BETTER FASTER GENTLER



Руководство пользователя «Аппарат физиотерапевтический для диатермии «RSHOCK»

Аппарат физиотерапевтический для диатермии	Модель: RSHOCK SN
 	Источник питания: 100-240 В ~ , 50/60 Гц Вес: макс.1.2 кг Потребляемая мощность: 90 ВА Внутреннее питание: 14.4 В пост.т. 3 350 мАч Непродолжительный режим: выключайте аппарат на 10 минут между каждым циклом, превышающим 10 минут. Диапазон частот: 2400-2483,5 МГц Передаваемая мощность: до 20 дБм макс.
    	Медицинское устройство. Не открывайте аппарат. Аппарат может использоваться только квалифицированными людьми.
  	WINBACK GO EAST #608, 200, Gieodosi-ro, jijeong -myeon, Wonju-si, Gangwon-Do, KOREA Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «РесортМед» 195112, г. Санкт-Петербург, Малаохтинский пр, дом 16, корпус 1, литера А, помещение 4Н.

Макет стикера на русском языке проводящего крема

Проводящий крем

Состав: Вода, Этилгексил пальмитат, Глицерин, Каприловый/каприновый триглицерид, Метилпропандиол, Гидрогенизированный полидецен циклопентасилоксан, Диметикон, Глицерил стеарат, C14-22 Алкоголь, ПЭГ-40 стеарат, Бетаин, 1,2-гександиол, Гидроксиацетофенон, ПЭГ-100 стеарат, C12-20 Алкилглюкозид, Глюкоза, Диметикон/винилдиметикон кроссполимер, Сополимер акрилоилдиметилтаурата аммония/ВП, Аргинин, Акрилаты/C10-30, алкилакрилатный кроссполимер, Каприлилгликоль, Цитрат натрия, Ароматизатор.

Осторожность:

1. Прекратите использование при появлении раздражения кожи, например, красных точек.
2. Закройте крышку после использования.
3. Храните его в недоступном для детей месте.
4. Не храните его при более высокой или низкой температуре и под прямыми солнечными лучами.

Как использовать:

Возьмите определенное количество крема и нанесите на кожу.

Объем: 750 мл

Производитель: WINBACK Go East Co., Ltd, Корея (#608, 200, Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-Do, 26354 Wonju, Republic of Korea)

Телефон/факс: +82 (0)33 813 3717

E-mail: info@winback.com

Web: www.winback.com

Изготовлено в Кореи

Годен до дд.мм.гг

Маркировки аксессуаров



200

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
29 (8824416) листов

Генеральный директор

должность

/Мамедов Д.Ю./

ФИО М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РесортМед»

Мамедов Д. Ю.


2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Аппарат физиотерапевтический для диатермии «RSHOCK»
производства компании
ВИНБЭК ГОУ ИСТ Ко., Лтд (WINBACK GO EAST Co., Ltd), Корея**



Parameters initialization...

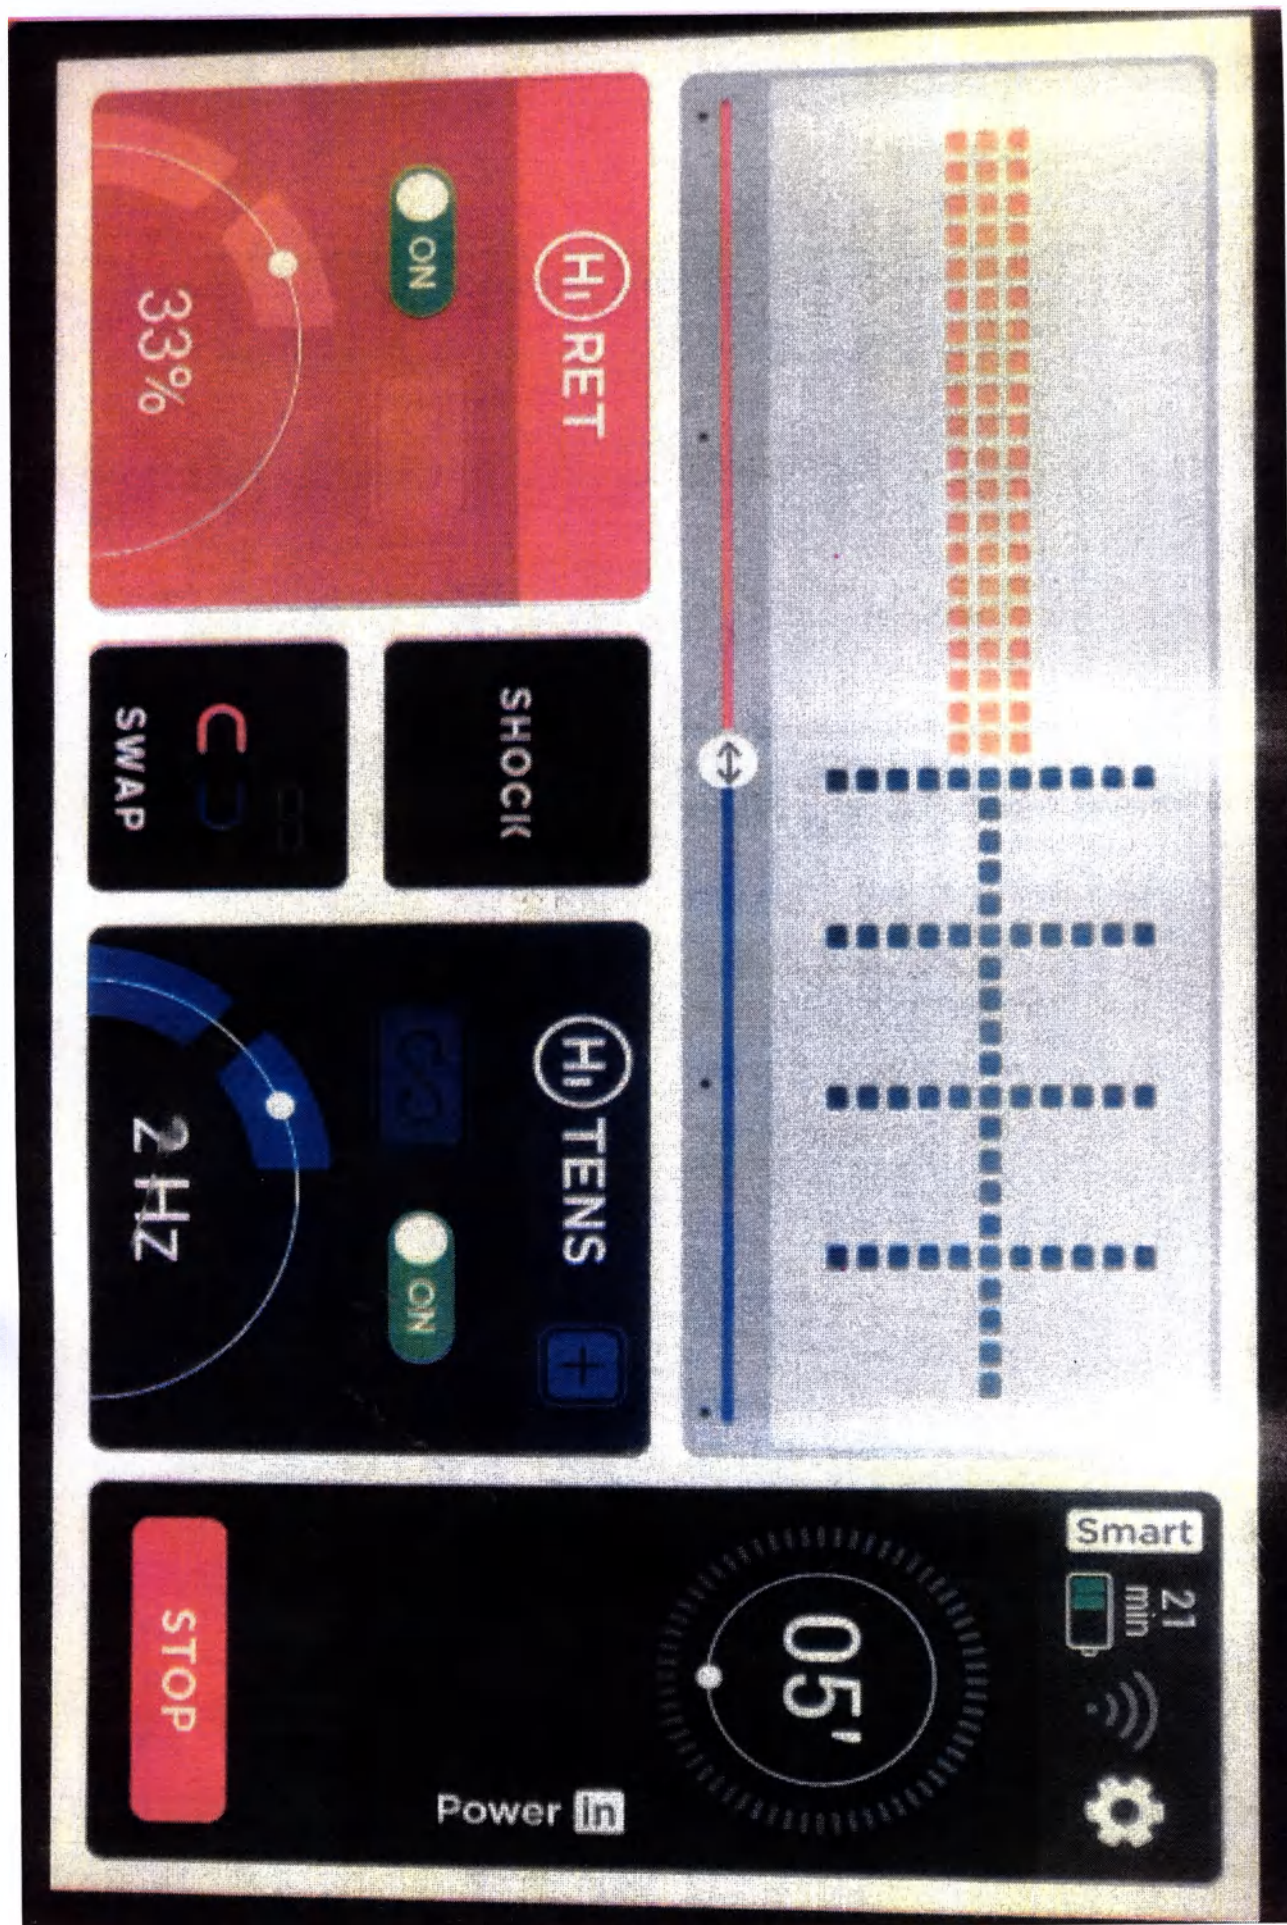



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листов

Генеральный директор

должность


подпись

/Мамедов Д.Ю./
ФИО М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РесортМед»


Мамедов Д. Ю.

2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
«Аппарат физиотерапевтический для диатермии «RSHOCK»
производства компании
ВИНБЭК ГОУ ИСТ Ко., Лтд (WINBACK GO EAST Co., Ltd), Корея**

Внешний вид транспортной картонной коробки: Аппарат физиотерапевтический для диатермии
«RSHOCK»

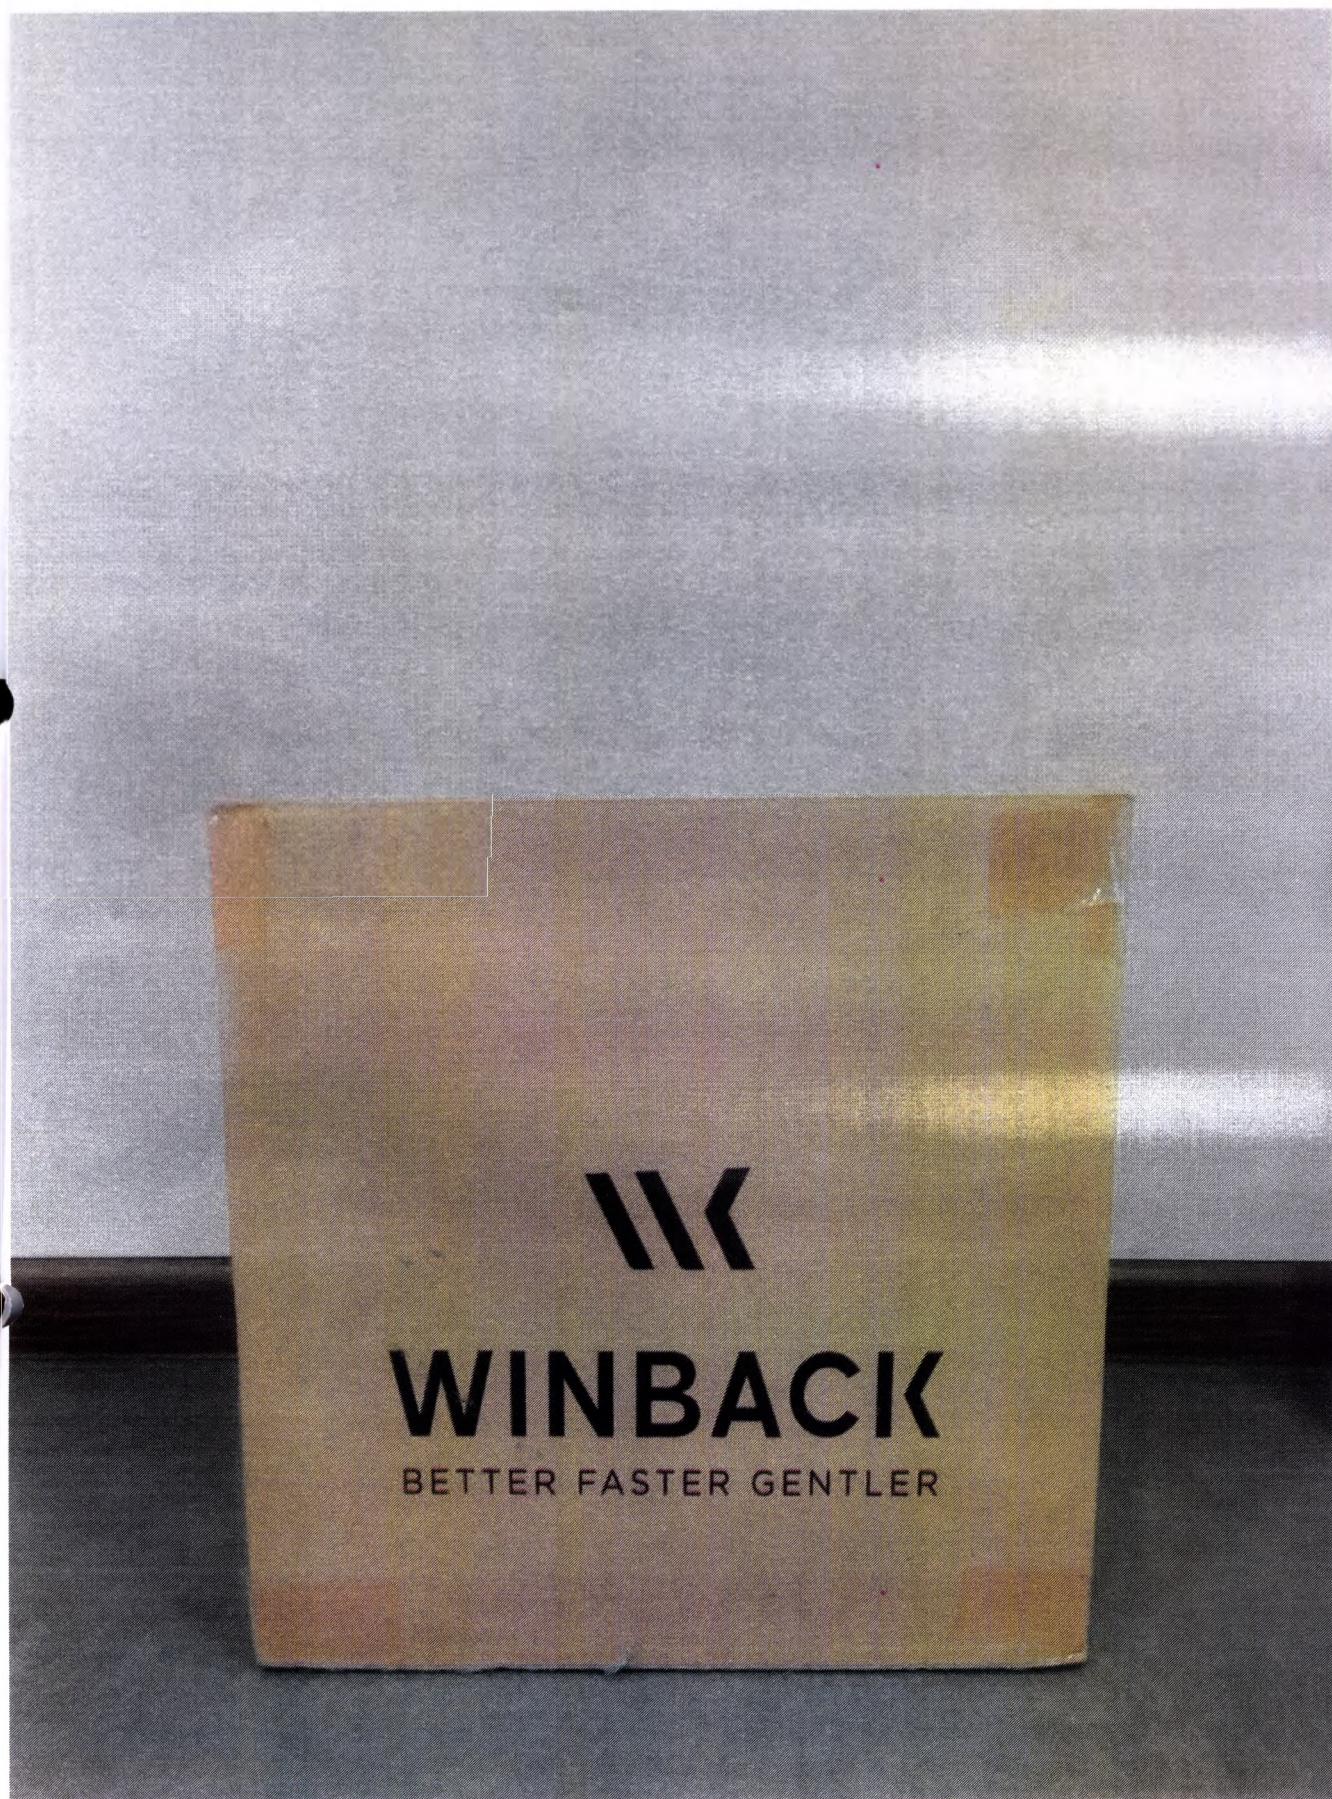

Внешний вид потребительской упаковки: Аппарат физиотерапевтический для диатермии
«RSHOCK»



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
(3) листов

Генеральный директор

должность

подпись

/Мамедов Д.Ю./

ФИО М.П.

