

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО
«Триалаб»



Н.С. Прозоровский

01» 01.08.2024 г.

МАРКИРОВКА

**Чистящий реагент для анализаторов гематологических
ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000
“TriaClean”
по ТУ 9398-002-13296835-2015**

ООО «Триалаб»

100 мл

TriaClean

Материал для очистки

от биологических загрязнений

Хранить в оригинальной упаковке

Хранить вдали от огня, источников

Возгорания, вдали от

Серия 0100224-100
Дата изготовления 01.2024
Срок годности 18 мес
РУ РЗН 2016/4352
ТУ 9398-002-13296835-2015

Адрес изготовителя 117321, г. Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100 Тел/факс:
(495) 255-06-63, e-mail info@trialab.ru

Только для in vitro диагностики.

Хранить и транспортировать +2°C – +35°C
Влажность не более 80%



☘ ООО «Триалаб»



Объем: 100 мл. Серия: 0100224-100
Дата изготовления: 01.2024
Срок годности: 18 мес
РУ РЗН 2016/4352
ТУ 9398-002-13296835-2015



Адрес изготовителя: 117321, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100 Тел/факс:
(495) 255-06-63, e-mail: info@trialab.ru

Только для in vitro диагностики
Хранить и транспортировать: +2°C – +35°C
Влажность не более 80%

ООО «Триалаб»

50 МД

TriaClean

Средство для очистки

и дезинфекции

для поверхностей и оборудования

в ветеринарных учреждениях

Ветеринарные учреждения

Серия: 0160224-50
Дата изготовления: 07.2024
Срок годности: 18 мес
РФ: РЗН 20164332
ТУ 9308-002-1329635-2015

Адрес изготовителя: 117321, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кп.100 Телефон:
(495) 235-08-63, e-mail: info@trialab.ru

Только для in vitro диагностики.
Хранить и транспортировать: +2°C — +25°C
Влажность не более 80%



ООО «Триалаб»



Объем: 50 мл. Серия: 0100224-58
Дата изготовления: 01.2024
Срок годности: 18 мес
РУ: РЗН 28164332
ТУ 9398-002-13296835-2018



Адрес изготовителя: 117321, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100 'Телефон':
(495) 235-09-63, e-mail: info@trilab.ru

Только для in vitro диагностики.
Хранить и транспортировать: +2°C – +35°C
Влажность не более 80%



ООО «Триалаб»

ООО «ТРИАЛАБ»
117321, г. Москва
ул. Профсоюзная, 152-3, кв. 100
ИНН 7728823796. Тел.: (495) 255-06-63
E-mail: Info@trialab.ru, www.trialab.ru

**Чистящий реагент для анализаторов
гематологических XT-4000i, XS-1000i,
XP-300 и XN-1000 «TriaClean»**

Вариант исполнения _____

Номер серии _____

Дата изготовления _____

Годен до _____

Дата групповой упаковки _____

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Реагент «TriaClean» должен храниться при температуре от +2°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°C).

Срок годности набора: 18 месяцев.

Условия транспортировки:

Реагент «TriaClean» рекомендуется транспортировать при температуре от +2°C до +35°C

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.



Фото 1. «Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, ХР-300 и ХН-1000 «TriaClean». Вариант исполнения I. Потребительская упаковка.

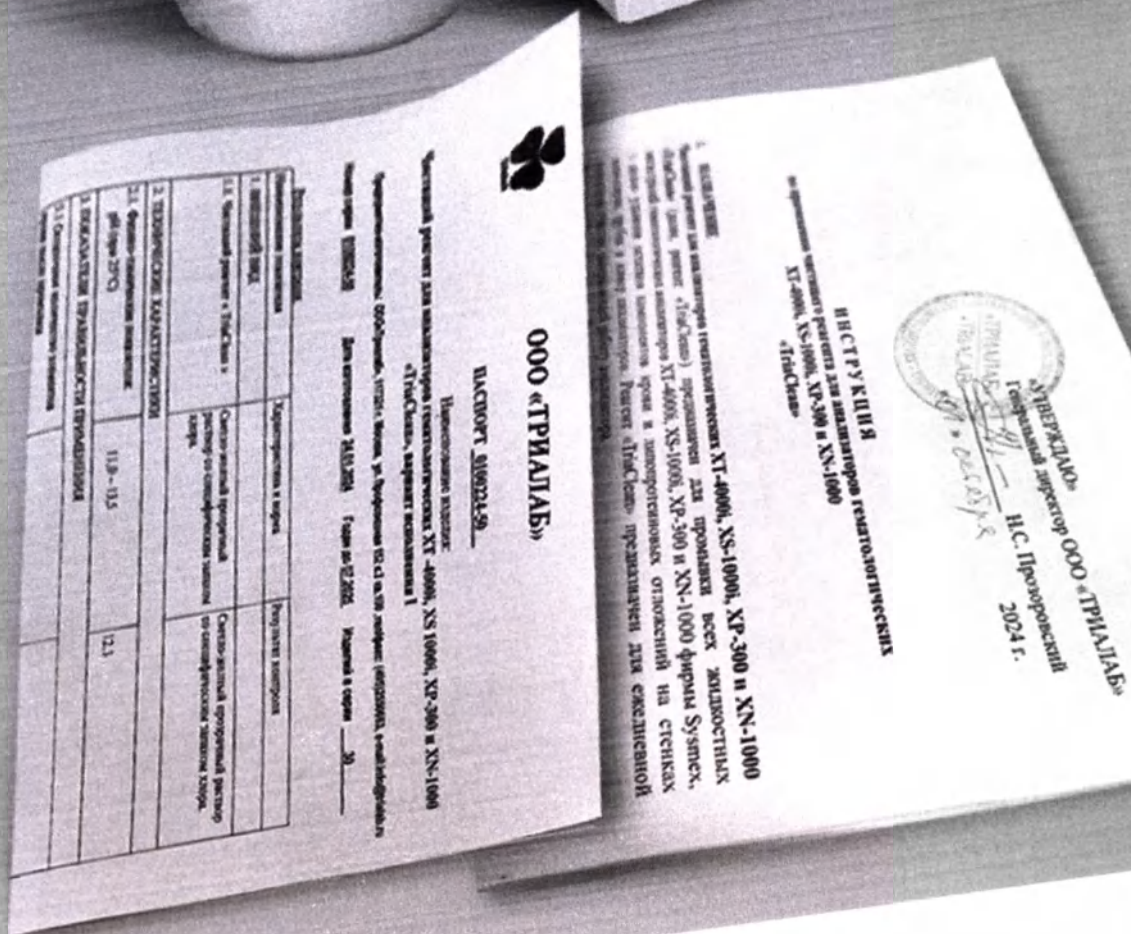


Фото 2. «Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 «TriaClean». Вариант исполнения II. Потребительская упаковка.



ООО «ТРИАЛАБ»

ПАСПОРТ 0100224-100

Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 «TriaClean», вариант исполнения II

Адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Профсоюзная, 152, к. 2, кв. 100 Тел: (495) 295-06-63, e-mail: info@trilab.ru

Дата изготовления: 01.2024
Срок годности: 12 мес
ТУ 0206-002-13290335-2015

ИНСТРУКЦИЯ

Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 «TriaClean»

1. Назначение: для очистки анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 от загрязнений.

2. Применение: для очистки анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 от загрязнений.

3. Хранение: в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от влаги и света месте.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Методы контроля
1. Внешний вид	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
2. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
3. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
4. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
5. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
6. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
7. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
8. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
9. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
10. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
11. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
12. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
13. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
14. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
15. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
16. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
17. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
18. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
19. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
20. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
21. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
22. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
23. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
24. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
25. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
26. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
27. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
28. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
29. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
30. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
31. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
32. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
33. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
34. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
35. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
36. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
37. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
38. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
39. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
40. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
41. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
42. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
43. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
44. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
45. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
46. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
47. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
48. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
49. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль
50. Чистящий реагент «TriaClean»	Светло-желтый порошок	Визуальный контроль

Фото 3. «Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 «TriaClean». Групповая упаковка. Общий вид.


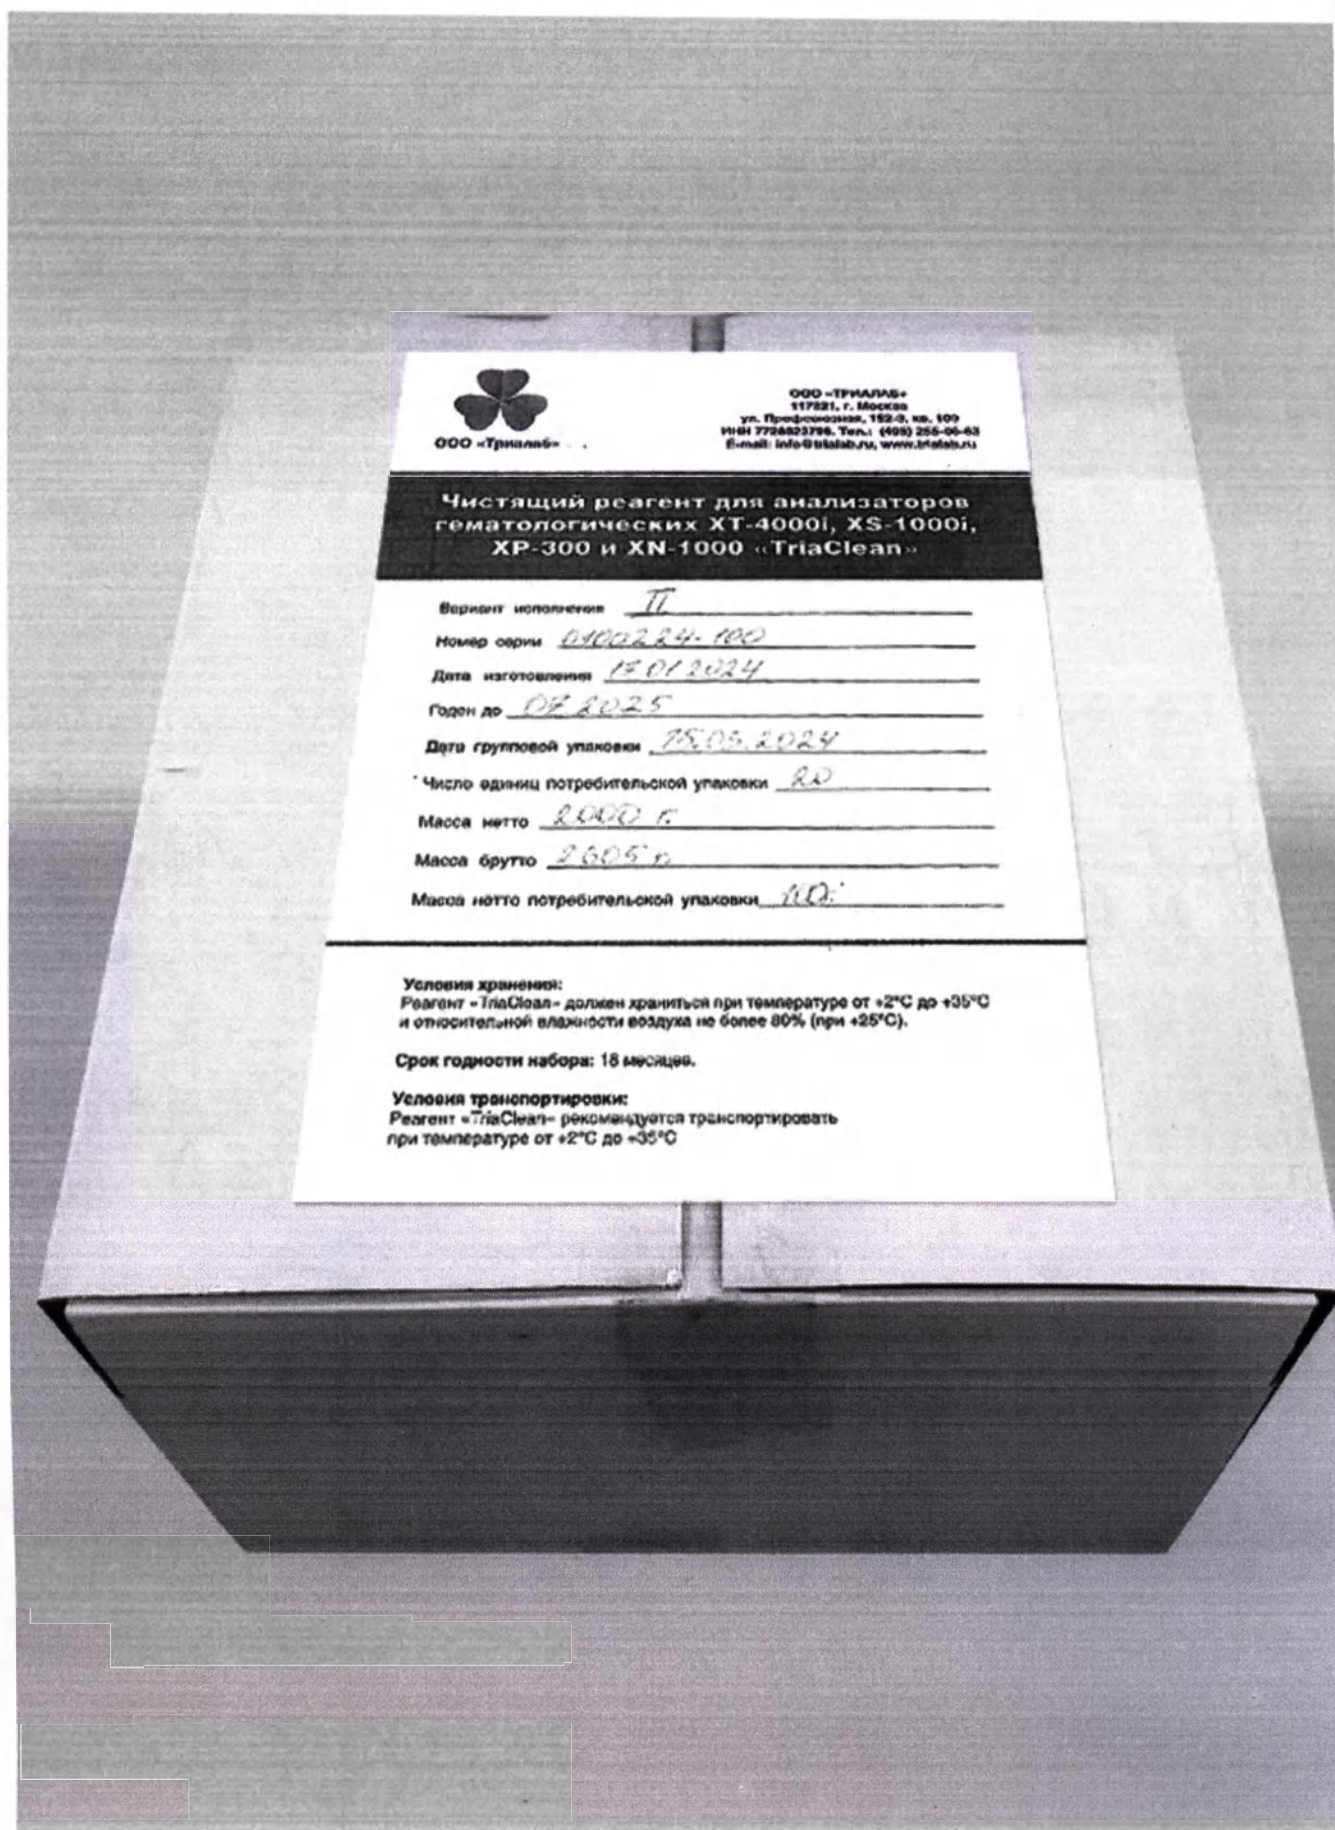


Фото 4. «Чистящий реагент для анализаторов гематологических ХТ-4000i, XS-1000i, XP-300 и XN-1000 «TriaClean». Групповая упаковка в открытом виде.



В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

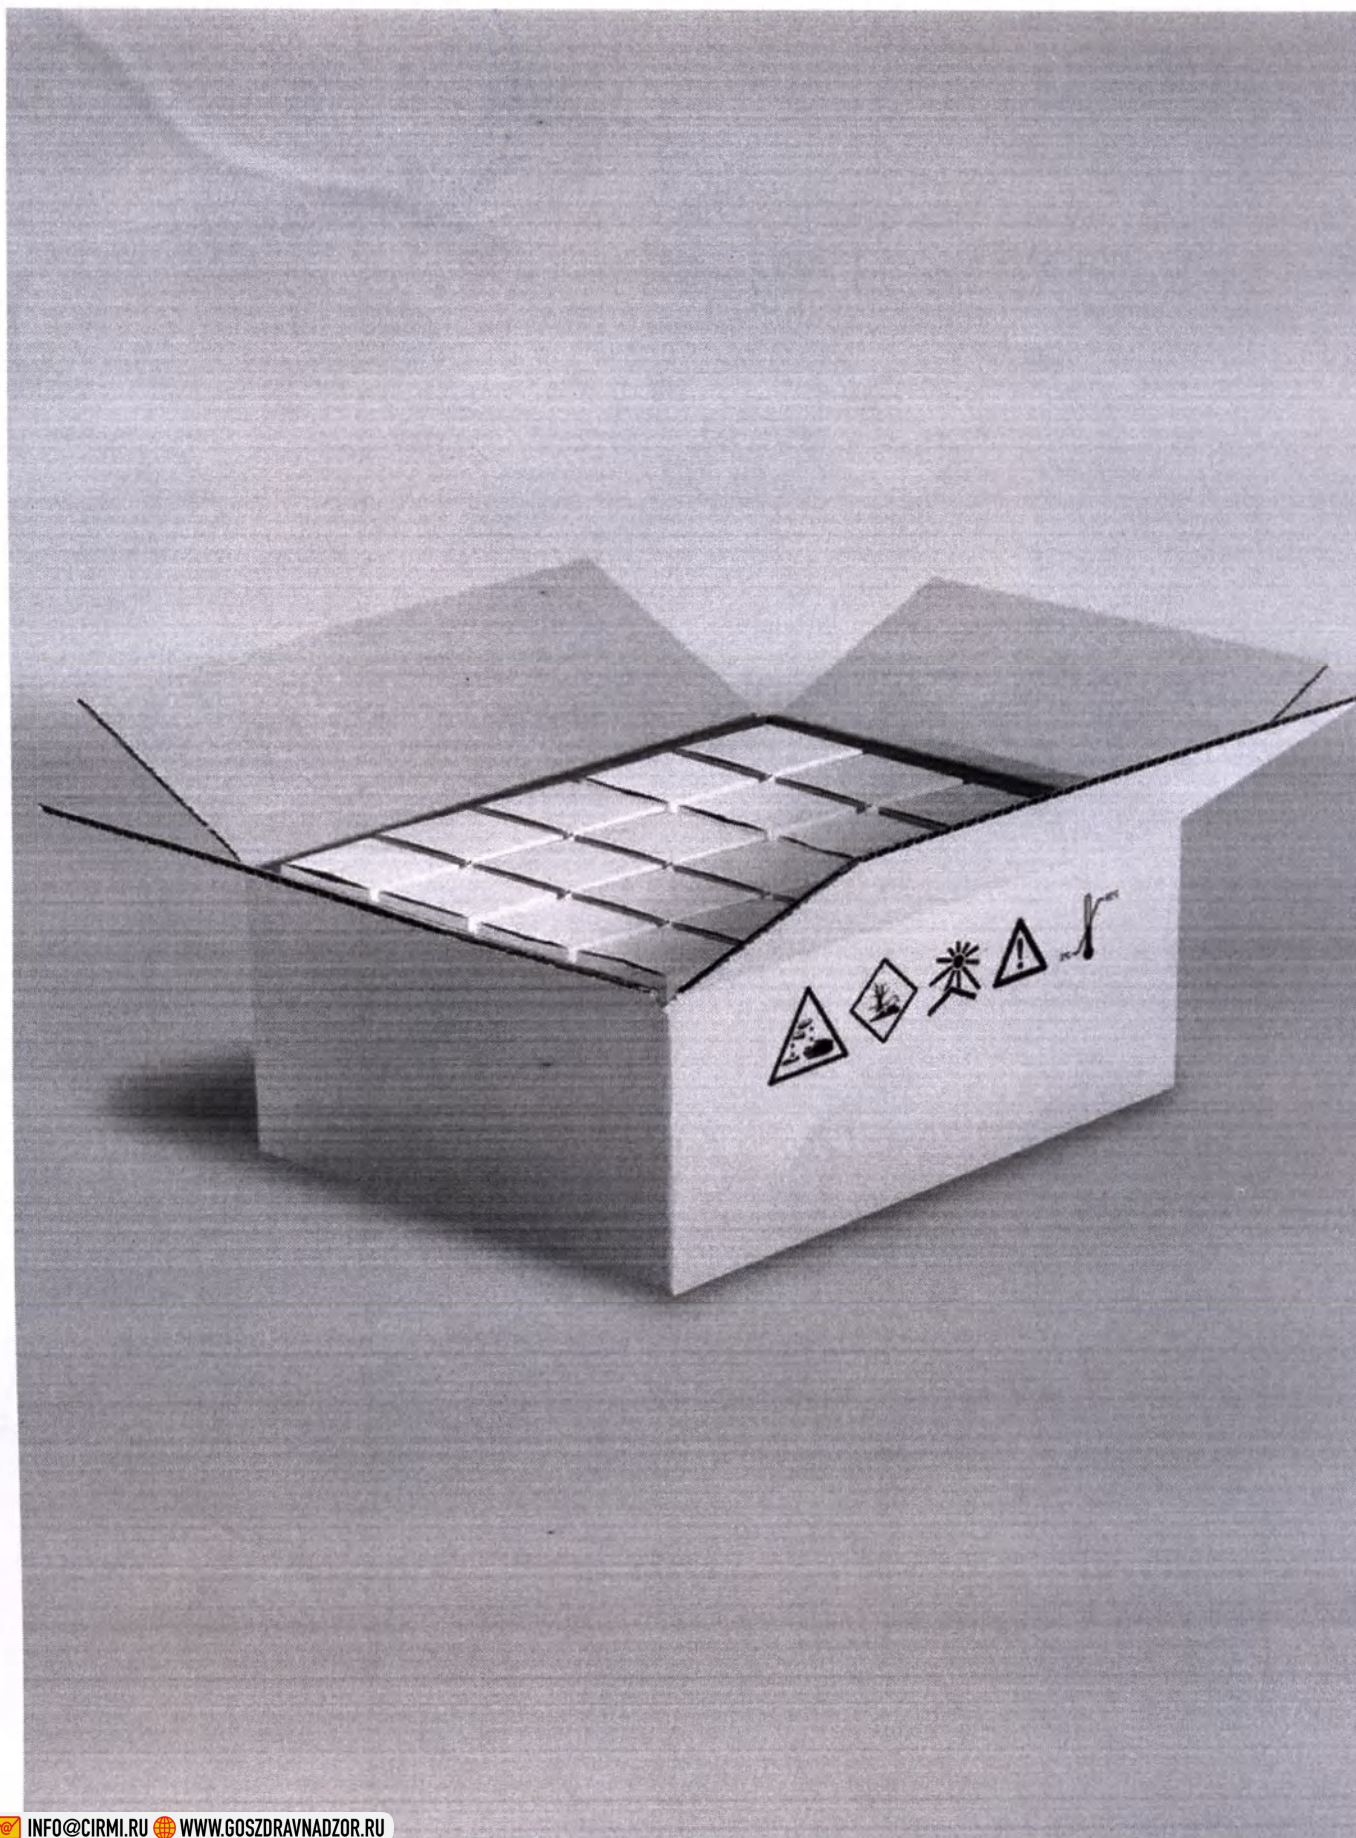

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.