

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТРИАЛАБ»



Н.С. Прозоровский

«*о.к.е.д.и*» 2024 г.

МАРКИРОВКА

Набора реагентов для анализаторов гематологических XS моделей 800i, 1000i
«Trialab XS» по ТУ 21.20.23-003 -13296835-2017

Набор «Tritalab XS»

42 мл

Производитель:  ООО «ТРИАДАВ»

**КРАСИТЕЛЬ
ДЛЯ ЛЕЙКОЦИТОВ**
(BioDye 4DS SYS)

Условия хранения: 2-35°C
Только для in vitro диагностики

Серия: 0200324
Дата изготовления: 18.01.2024
Годен до: 07.2025

Реагент произведен: Бюлоф, Венгрия

Набор «Trialab XS»

Производитель:  ООО «ТРИАЛАБ»

20 л

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР (BioDil SYS)

Условия хранения: 2-35°C

Только для in vitro диагностики

Реагент произведен: Biochol, Венгрия

Серия: 0200324

Дата изготовления: 19.01.2024

Годен до: 07.2025

Набор «Trialab XS»

Производитель:  ООО «ТРИАЛАБ»

5 л

ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ ЛЕЙКОЦИТОВ (BioLyse-4DL SYS)

Условия хранения: 2-35°C

Серия: 0200324

Только для in vitro диагностики

Дата изготовления: 19.01.2024

Реагент произведен: Biohol, Венгрия

Годен до: 07.2025

Набор «Trialab XS»

Производитель:  ООО «ТРИАЛАБ»

5 л

ЛИЗИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА (BioGlobin SYS)

Условия хранения: 2-35°C

Серия: 0200324

Только для in vitro диагностики

Дата изготовления: 19.01.2024

Реагент произведен: Biohol, Венгрия

Годен до: 07.2025

Набор реагентов для анализаторов гематологических XS моделей 800i, 1000i «Trialab XS» по ТУ 21.20.23-003-13296835-2017

Состав набора

Комплектация (2000 исследований)

1. Изотонический раствор (BioDil SYS)	Канистра 20 л	4 шт
2. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)	Канистра 5 л	1 шт
3. Краситель для лейкоцитов (BioDye-4DS SYS)	Пакет 42 мл	3 шт
4. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)	Канистра 5 л	1 шт

Производитель:



ООО «ТРИАЛАБ»

117321, г. Москва, ул. Профсоюзная, 152, к. 3, кв. 100
Тел. +7 (495) 255-06-63, e-mail: info@trialab.ru
www.trialab.ru

ТУ 21.20.23-003-13296835-2017

РУ № РЗН 2018/6936

Серия: 0200324

Дата изготовления: 19.01.2024

Годен до: 07.2025

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

«ТРИАЛАБ»
«TRIALAB»

» Генеральный директор
ООО «Триалаб»

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фото 1. Набор реагентов «Trialab XS». Потребительская упаковка.

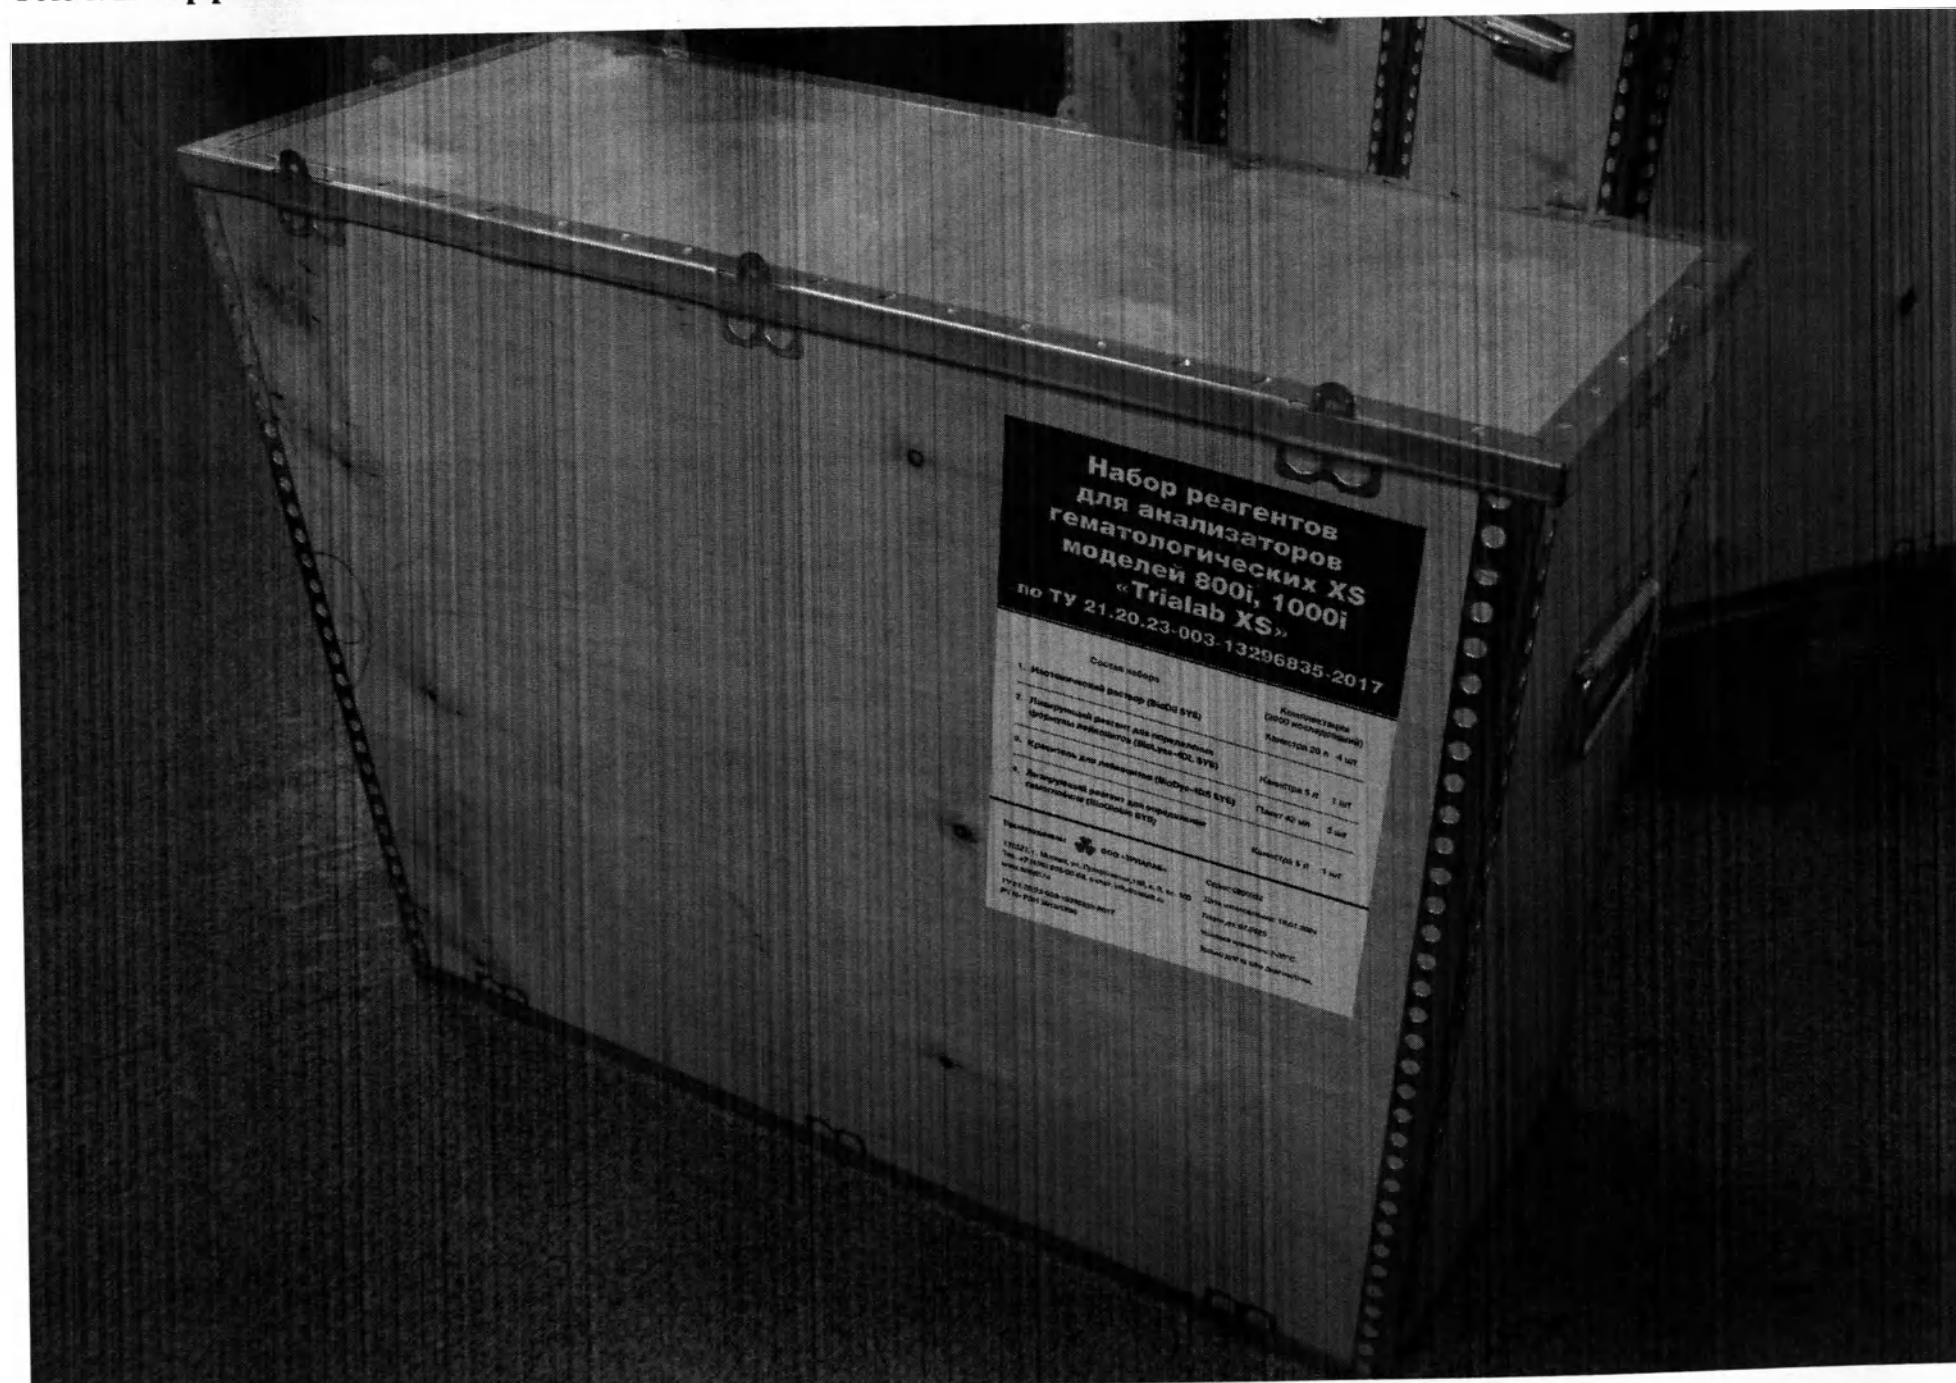


Фото 2. Набор реагентов «Trialab XS». Изотонический раствор (BioDil SYS).

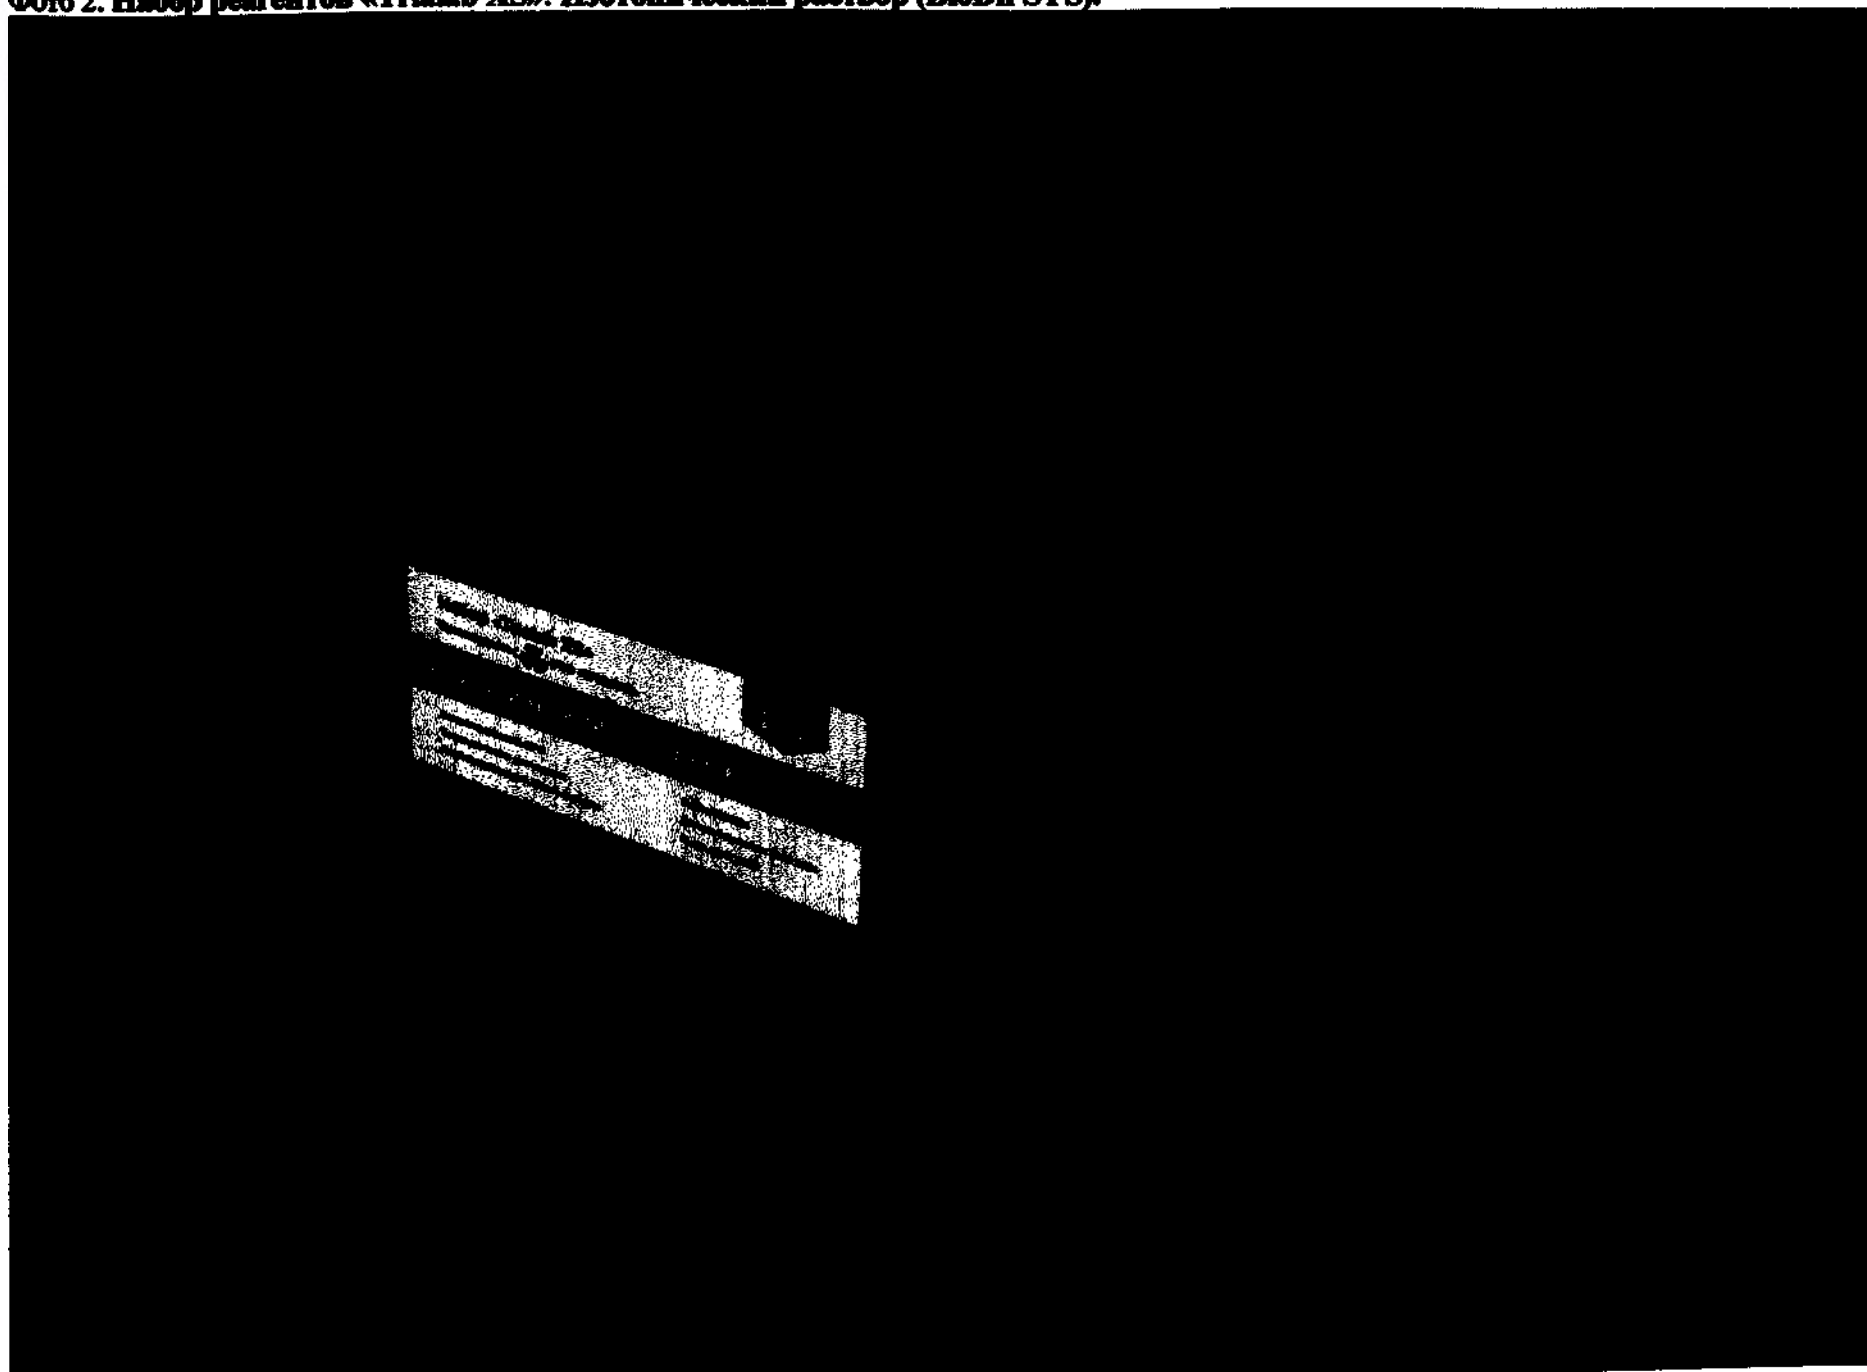








Фото 5. Набор реагентов «Ttrialab XS». Краситель для лейкоцитов (BioDye-4DS SYS)





В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.