



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СОЛТ»

В. В. Заяц

«28» июня 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор автоматический гибридный мочевого US-1000

производства

URIT Medical Electronic Co., Ltd. (УРИТ Медикал Электроник Ко., Лтд.), Китай

Наименование и состав медицинского изделия:

Анализатор автоматический гибридный мочевой US-1000, в составе:

1. Основной блок анализатора US-1000 – 1 шт.
2. Бак для отходов, 20 л – 1 шт.
3. Трубка к баку для отходов с датчиком наполнения с кабелем – 1 шт.
4. Ключ для снятия крышек – 1 шт.
5. Бутыль для раствора промывающего D21N, 5 л – 1 шт.
6. Трубка для раствора промывающего D21N – 1 шт.
7. Трубка для раствора проточных измерений S11 – 1 шт.
8. Держатель крышки раствора проточных измерений S11 – 1 шт.
9. Спринцовка – 1 шт.
10. Мандрен стальной – 1 шт.
11. Мандрен мягкий – 1 шт.
12. Щетка для обслуживания – 1 шт.
13. Смазка для технического обслуживания – 1 шт.
14. Ключ для боковой дверцы – 1 шт.
15. Штатив для пробирок – 10 шт.
16. Пробирка с завинчивающейся прокалываемой крышкой, 10 мл – 1 уп. х 100 шт.
17. Адаптер для пробирок диаметром 14 мм и высотой 100 мм – 1 уп. х 100 шт.
18. Пластиковая трубка, 5 м – 1 шт.
19. Модуль управления – 1 шт.
20. Монитор – 1 шт.
21. Клавиатура – 1 шт.
22. Манипулятор «мышь» - 1 шт.
23. Кабель LAN, 1,5 м – 1 шт.
24. Сканер штрих-кода ручной – 1 шт.
25. Держатель сканера штрих-кода – 1 шт.
26. Кабель соединительный к модулю управления – 1 шт.
27. Кабель питания – 3 шт.
28. Тест-полоски проверочные – 2 шт.
29. Предохранитель – 2 шт. (при необходимости)
30. Адаптер для пробирок диаметром от 12 до 13 мм и высотой 100 мм – 1 уп. х 100 шт. (при необходимости)
31. Коврик для манипулятора «мышь» - 1 шт. (при необходимости)
32. Свитч (коммутатор), 100М – 1 шт. (при необходимости)
33. Сетевой кабель, 3 м – 2 шт. (при необходимости)
34. Калибратор модуля SG (1 фл. по 8 мл) - 2 шт. (при необходимости)
35. Калибратор мутности (1 фл. по 8 мл) - 2 шт. (при необходимости)
36. Этикетка качества – 1 шт. (при необходимости)
37. Атлас осадков мочи -1 шт. (при необходимости)
38. Памятка о запуске – 1 шт. (при необходимости)
39. Краткое руководство по эксплуатации – 1 шт. (при необходимости)
40. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Рисунок 1 – Анализатор. Общий вид

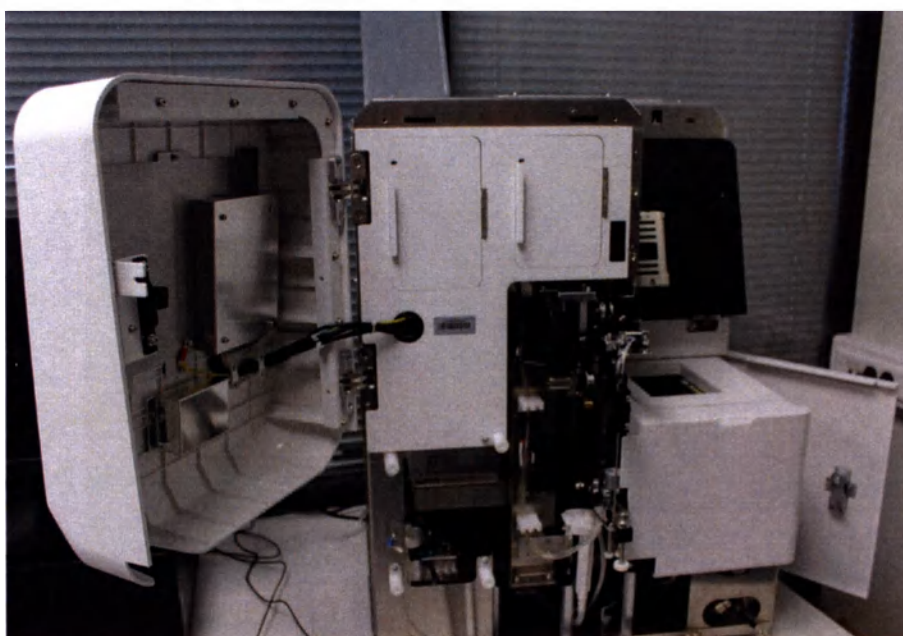


Рисунок 2 – Анализатор. Вид спереди с открытой крышкой

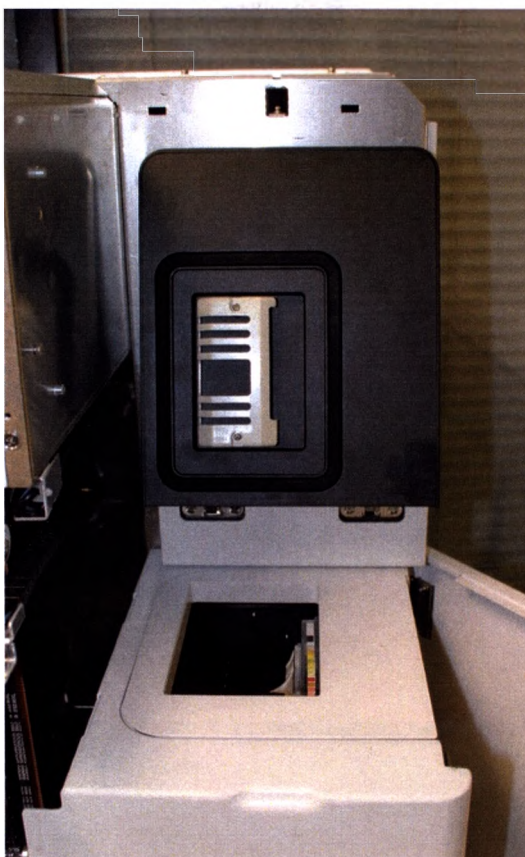


Рисунок 3 – Анализатор. Зона загрузки тест-полосок



Рисунок 4 – Анализатор. Вид сзади



Рисунок 5 – Бак для отходов, 20 л

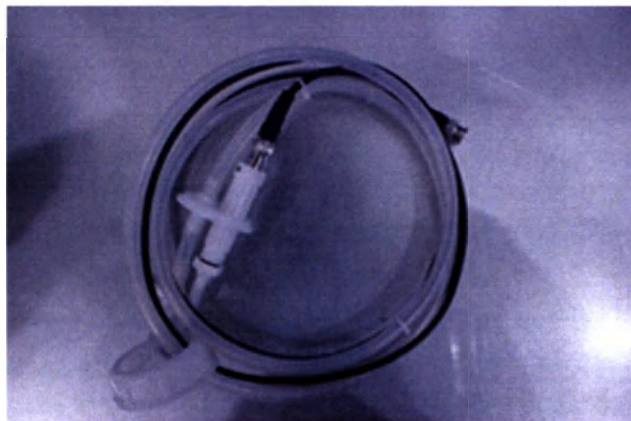


Рисунок 6 – Трубка к баку для отходов с датчиком наполнения с кабелем



Рисунок 7 – Ключ для снятия крышек



Рисунок 8 – Бутыль для раствора, промывающего D21N, 5 л

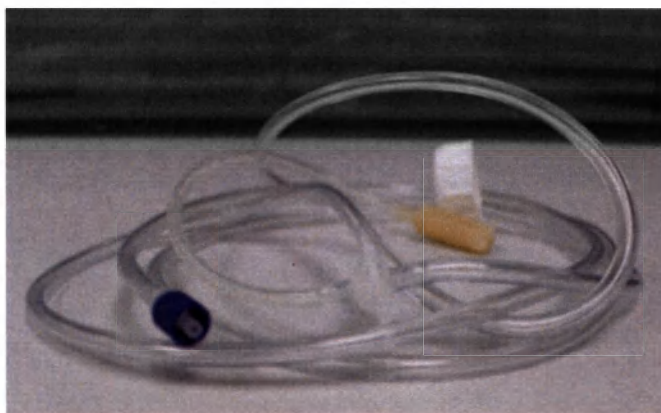


Рисунок 9 – Трубка для раствора промывающего D21N



Рисунок 10 – Трубка для раствора проточных измерений S11



Рисунок 11 – Держатель крышки раствора проточных измерений S11



Рисунок 12 – Спринцовка

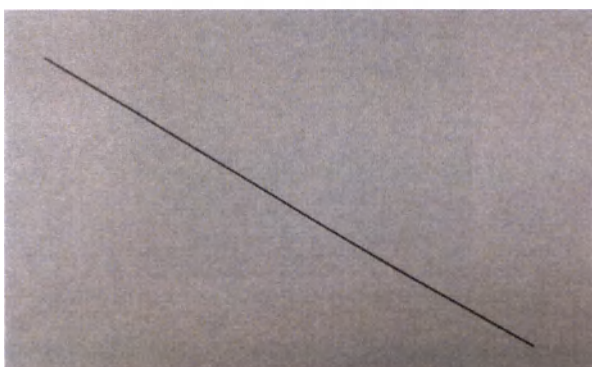


Рисунок 13 – Мандрен стальной

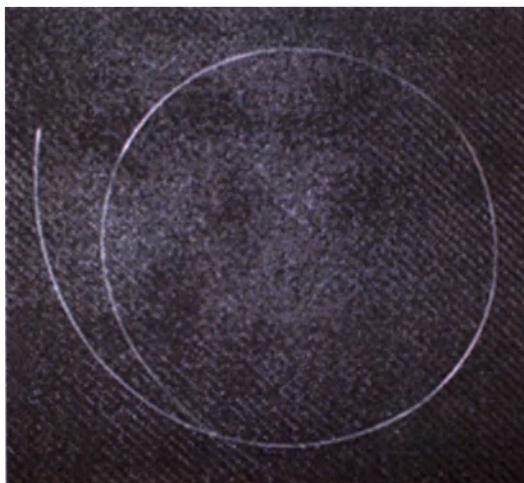


Рисунок 14 – Мандрен мягкий



Рисунок 15 – Щетка для обслуживания

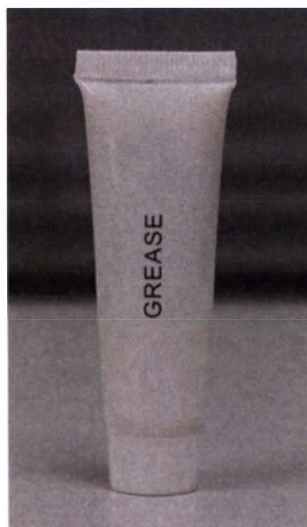


Рисунок 16 – Смазка для технического обслуживания



Рисунок 17 – Ключ для боковой дверцы

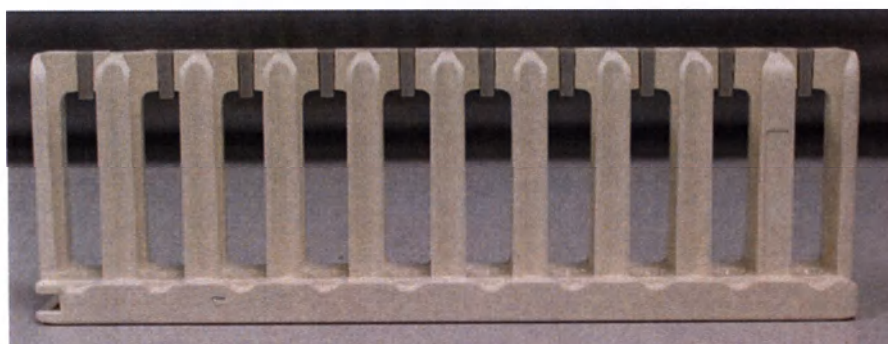


Рисунок 18 – Штатив для пробирок



Рисунок 19 – Пробирка с завинчивающейся прокалываемой крышкой, 10 мл



Рисунок 20 – Адаптер для пробирок диаметром 14 мм и высотой 100 мм



Рисунок 21 – Пластиковая трубка, 5 м



Рисунок 22 – Модуль управления



Рисунок 23 – Монитор



Рисунок 24 – Клавиатура

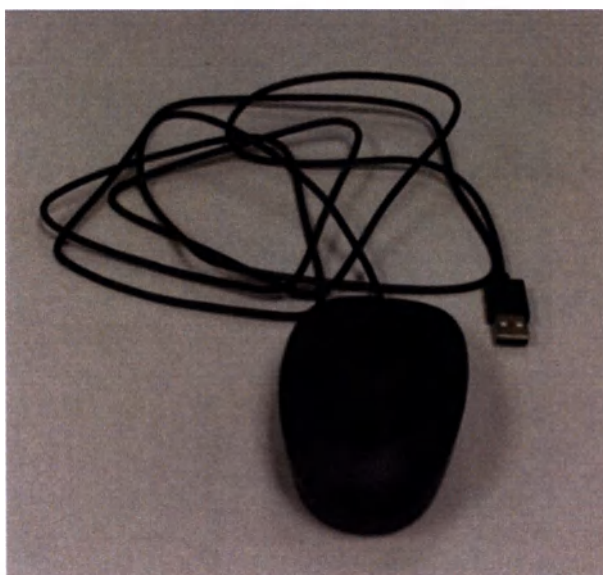


Рисунок 25 – Манипулятор «мышь»



Рисунок 26 – Кабель LAN, 1,5 м



Рисунок 27 - Сканер штрих-кода ручной



Рисунок 28 – Держатель сканера штрих-кода



Рисунок 29 – Кабель соединительный к модулю управления

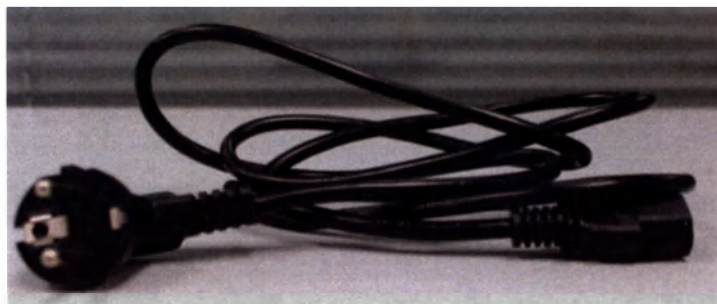


Рисунок 30 – Кабель питания



Рисунок 31 – Тест-полоски проверочные



Рисунок 32 – Предохранитель



Рисунок 33 – Адаптер для пробирок диаметром от 12 до 13 мм и высотой 100 мм



Рисунок 34 – Коврик для манипулятора «мышь»



Рисунок 35 – Свитч (коммутатор), 100M



Рисунок 36 – Сетевой кабель, 3 м

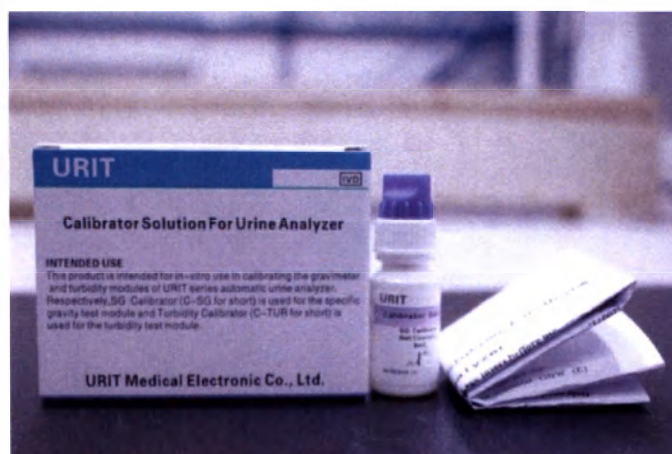


Рисунок 37 – Калибратор модуля SG

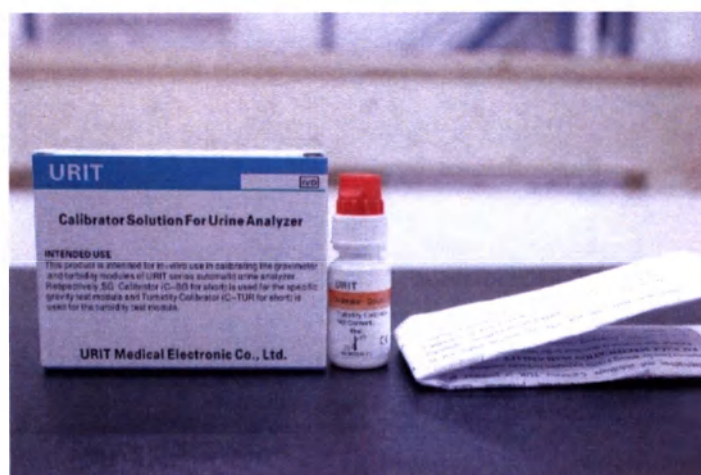


Рисунок 38 – Калибратор мутности

Фотографические изображения маркировки медицинского изделия

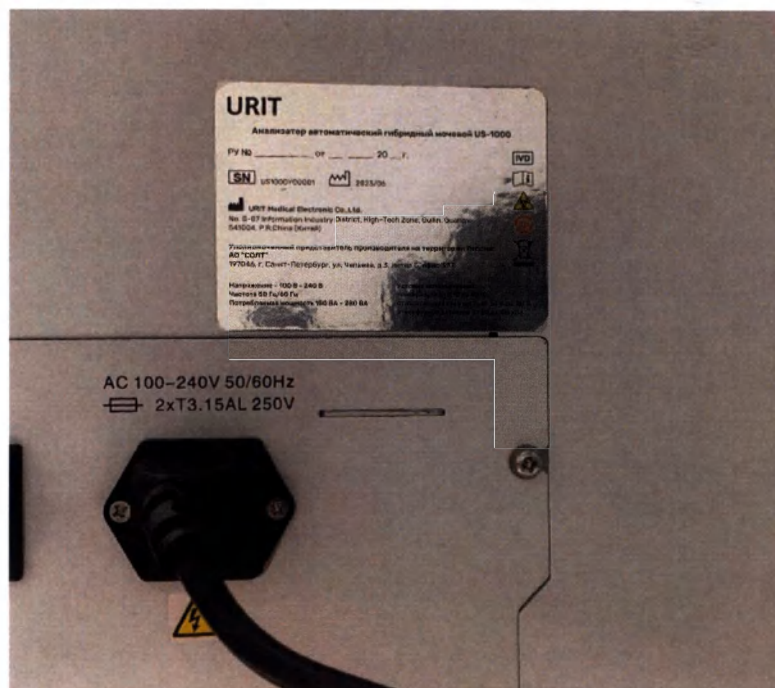


Рисунок 39 – Анализатор. Фото этикетки



Рисунок 40 – Транспортная упаковка анализатора

Прошито и скреплено печатью
на 15 листах
Генеральный директор
АО «СОЛТ»
Заяц В.В.

