

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Сирона Денталь Системс»**



К.Г. Левин

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ, "17" сентября 2024 г.
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых
трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan AC, CEREC Primescan AC,
Omnicam AC, CEREC Omnicam AC, CEREC AF Omnicam, CEREC AF Connect
Omnicam, Primescan Connect с принадлежностями**

производства SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan AC:	7
1.	Блок для съемки с тачпадом или блок для съемки с шаровым манипулятором.	8
2.	Монитор.	9
3.	Камера внутриротовая Primescan (CEREC Primescan).	10
	Кабель питания.	11
4.	Кабель питания модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай	12
5.	Насадка калибровочная для настройки точности.	13
6.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	14
7.	Наконечник металлический для камеры Primescan:	
	7.1. с несъемным стеклом	15
	7.2. со съемным стеклом	16
8.	Наконечник одноразовый для камеры Primescan.	17
9.	Заглушка пластиковая для камеры.	18
10.	USB носитель с программными лицензиями.	19
11.	Фантом Модель челюсти.	20
12.	Крепеж кабеля питания.	21
13.	Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.	22
14.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе.	23
15.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера.	24
16.	Лицензионные коды License Voucher.	25
17.	Винт крепежный для аккумулятора.	26
18.	Эксплуатационная документация, в составе:	
	18.1. инструкция по эксплуатации;	27
	18.2. инструкция по установке;	28
	18.3. руководство по распаковке.	29
	Принадлежности:	
1.	Аккумулятор литий-ионный.	30
II.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Primescan AC:	31
1.	Блок для съемки с тачпадом или блок для съемки с шаровым манипулятором.	32
2.	Монитор.	33
3.	Камера внутриротовая Primescan (CEREC Primescan).	34
	Кабель питания.	35
4.	Кабель питания модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай	36
5.	Насадка калибровочная для настройки точности.	37
6.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	38
7.	Наконечник металлический для камеры Primescan:	
	7.1. с несъемным стеклом	39
	7.2. со съемным стеклом	40
8.	Наконечник одноразовый для камеры Primescan.	41
9.	Заглушка пластиковая для камеры.	42
10.	USB носитель с программными лицензиями.	43
11.	Фантом Модель челюсти.	44
12.	Крепеж кабеля питания.	45
13.	Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.	46
14.	Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе.	47

15.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе	48
16.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера	49
17.	Лицензионные коды License Voucher.	50
18.	Винт крепежный для аккумулятора.	51
19.	Эксплуатационная документация, в составе:	
19.1.	инструкция по эксплуатации;	52
19.2.	инструкция по установке;	53
19.3.	руководство по распаковке.	54
Принадлежности:		
1.	Аккумулятор литий-ионный.	55
III.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Omnicam AC:	56
1.	Блок для съемки с тачпадом или блок для съемки с шаровым манипулятором.	57
2.	Монитор.	58
3.	Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam).	59
	Кабель питания.	60
4.	Кабель питания модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай	61
5.	Насадка калибровочная для настройки точности.	62
6.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	63
7.	Наконечник одноразовый для камеры Omnicam.	64
8.	USB носитель с программными лицензиями.	65
9.	Фантом Модель челюсти.	66
10.	Крепеж кабеля питания.	67
11.	Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.	68
12.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе	69
13.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера	70
14.	Лицензионные коды License Voucher.	71
15.	Винт крепежный для аккумулятора.	72
16.	Эксплуатационная документация, в составе:	
16.1.	инструкция по эксплуатации;	73
16.2.	инструкция по установке;	74
16.3.	руководство по распаковке.	75
Принадлежности:		
1.	Аккумулятор литий-ионный.	76
IV.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Omnicam AC:	77
1.	Блок для съемки с тачпадом или блок для съемки с шаровым манипулятором.	78
2.	Монитор.	79
3.	Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam).	80
	Кабель питания.	81
4.	Кабель питания модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай	82
5.	Насадка калибровочная для настройки точности.	83
6.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	84
7.	Наконечник одноразовый для камеры Omnicam.	85
8.	USB носитель с программными лицензиями.	86
9.	Фантом Модель челюсти.	87
10.	Крепеж кабеля питания.	88
11.	Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.	89

12.	Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе.	90
13.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе	91
14.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера	92
15.	Лицензионные коды License Voucher.	93
16.	Винт крепежный для аккумулятора.	94
17.	Эксплуатационная документация, в составе:	
17.1.	инструкция по эксплуатации;	95
17.2.	инструкция по установке;	96
17.3.	руководство по распаковке.	97
Принадлежности:		
1.	Аккумулятор литий-ионный.	98
V.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Omnicam:	99
1.	Камера внутриворотная Omnicam (CEREC Omnicam)	100
2.	Держатель камеры	101
3.	Насадка калибровочная для настройки точности	102
4.	Насадка калибровочная для настройки цвета	103
5.	Защитные крышки	104
6.	Кабель соединительный для держателя камеры - 3 м или 5 м или 10 м	105
7.	Кабель удлинительный для камеры	106
8.	Кабель USB	107
9.	Соединительная коробка	108
10.	Медицинский блок питания	109
	Кабель сетевой медицинского блока питания	110
11.	Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания	111
12.	Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде.	112
13.	Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе	113
14.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе	114
15.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера	115
16.	Лицензионные коды License Voucher	116
17.	USB носитель с программными лицензиями	117
18.	Одноразовые утилизируемые гигиенические защитные чехлы для планшета	118
19.	Стойка планшета для стола	119
20.	ПК специальный	120
21.	Антенны WiFi адаптера ПК	121
22.	Кабель сетевой питания ПК	122
23.	Клавиатура и мышь	123
24.	Кабель ЛВС (LAN) для ПК	124
25.	Программный модуль для тестирования работы ПК (PC Diagnostic tool) на электронном носителе	125
26.	Программный модуль для сброса настроек ПК к заводским (Dentsply Sirona Restore Solution) на электронном носителе	126
27.	Программный модуль для удаленной передачи изображения с монитора ПК на планшет (Sirona Remote) на электронном носителе	127
28.	Инструкция по эксплуатации на электронном носителе	128
VI.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Connect Omnicam:	129
1.	Камера внутриворотная Omnicam (CEREC Omnicam).	130
2.	Держатель камеры.	131
3.	Насадка калибровочная для настройки точности.	132

4.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	133
5.	Защитные крышки – не более 5 шт.	134
6.	Кабель соединительный для держателя камеры - 3 м или 5 м или 10 м.	135
7.	Кабель удлинительный для камеры.	136
8.	Кабель USB.	137
9.	Соединительная коробка Connect.	138
10.	Медицинский блок питания.	139
	Кабель сетевой медицинского блока питания.	140
11.	Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания	141
12.	Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде.	142
13.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе.	143
14.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера.	144
15.	Лицензионные коды License Voucher	145
16.	USB носитель с программными лицензиями.	146
17.	Одноразовые утилизируемые гигиенические защитные чехлы для планшета.	147
18.	Стойка планшета для стола.	148
19.	ПК специальный.	149
20.	Антенны WiFi адаптера ПК.	150
21.	Кабель сетевой питания ПК.	151
22.	Клавиатура и мышь.	152
23.	Кабель ЛВС (LAN) для ПК.	153
24.	Программный модуль для тестирования работы ПК (PC Diagnostic tool) на электронном носителе.	154
25.	Программный модуль для сброса настроек ПК к заводским (Dentsply Sirona Restore Solution) на электронном носителе.	155
26.	Программный модуль для удаленной передачи изображения с монитора ПК на планшет (Sirona Remote) на электронном носителе (при необходимости).	156
27.	Инструкция по эксплуатации на электронном носителе.	157
VII.	Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan Connect:	158
1.	Камера внутриротовая Primescan.	159
2.	Держатель камеры.	160
3.	Соединительная коробка.	161
4.	Насадка калибровочная для настройки точности.	162
5.	Насадка калибровочная для настройки цвета.	163
6.	Наконечник металлический для камеры Primescan	164
7.	Наконечник одноразовый для камеры Primescan.	165
8.	Заглушка пластиковая для камеры.	166
9.	Уплотнительные кольца O-rings.	167
10.	Кабель USB.	168
11.	Оригинальный кейс для хранения камеры внутриротовой Primescan.	169
12.	USB носитель с программными лицензиями.	170
13.	Медицинский блок питания соединительной коробки.	171
14.	Кабель сетевой медицинского блока питания соединительной коробки.	172
	Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания соединительной коробки.	173
15.	Ноутбук.	174
16.	Медицинский блок питания ноутбука.	175

17.	Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания ноутбука.	176
	Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания ноутбука	177
18.	Ватные палочки для ухода.	178
19.	Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде или загружаемое с сервера.	179
20.	Программное обеспечение CEREC Ortho SW загружаемое с сервера или на электронном носителе.	180
21.	Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера.	181
22.	Лицензионные коды License Voucher.	182
23.	Брошюра Quick Start Guide на бумажном носителе.	183
24.	Инструкция по эксплуатации, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе.	184
	Макет маркировки на русском языке	185

I. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan AC:




1. Блок для съемки с тандемом или блок для съемки с шаровым манипулятором.



2. Монитор.



3. Камера внутриротовая Primescan (CEREC Primescan).

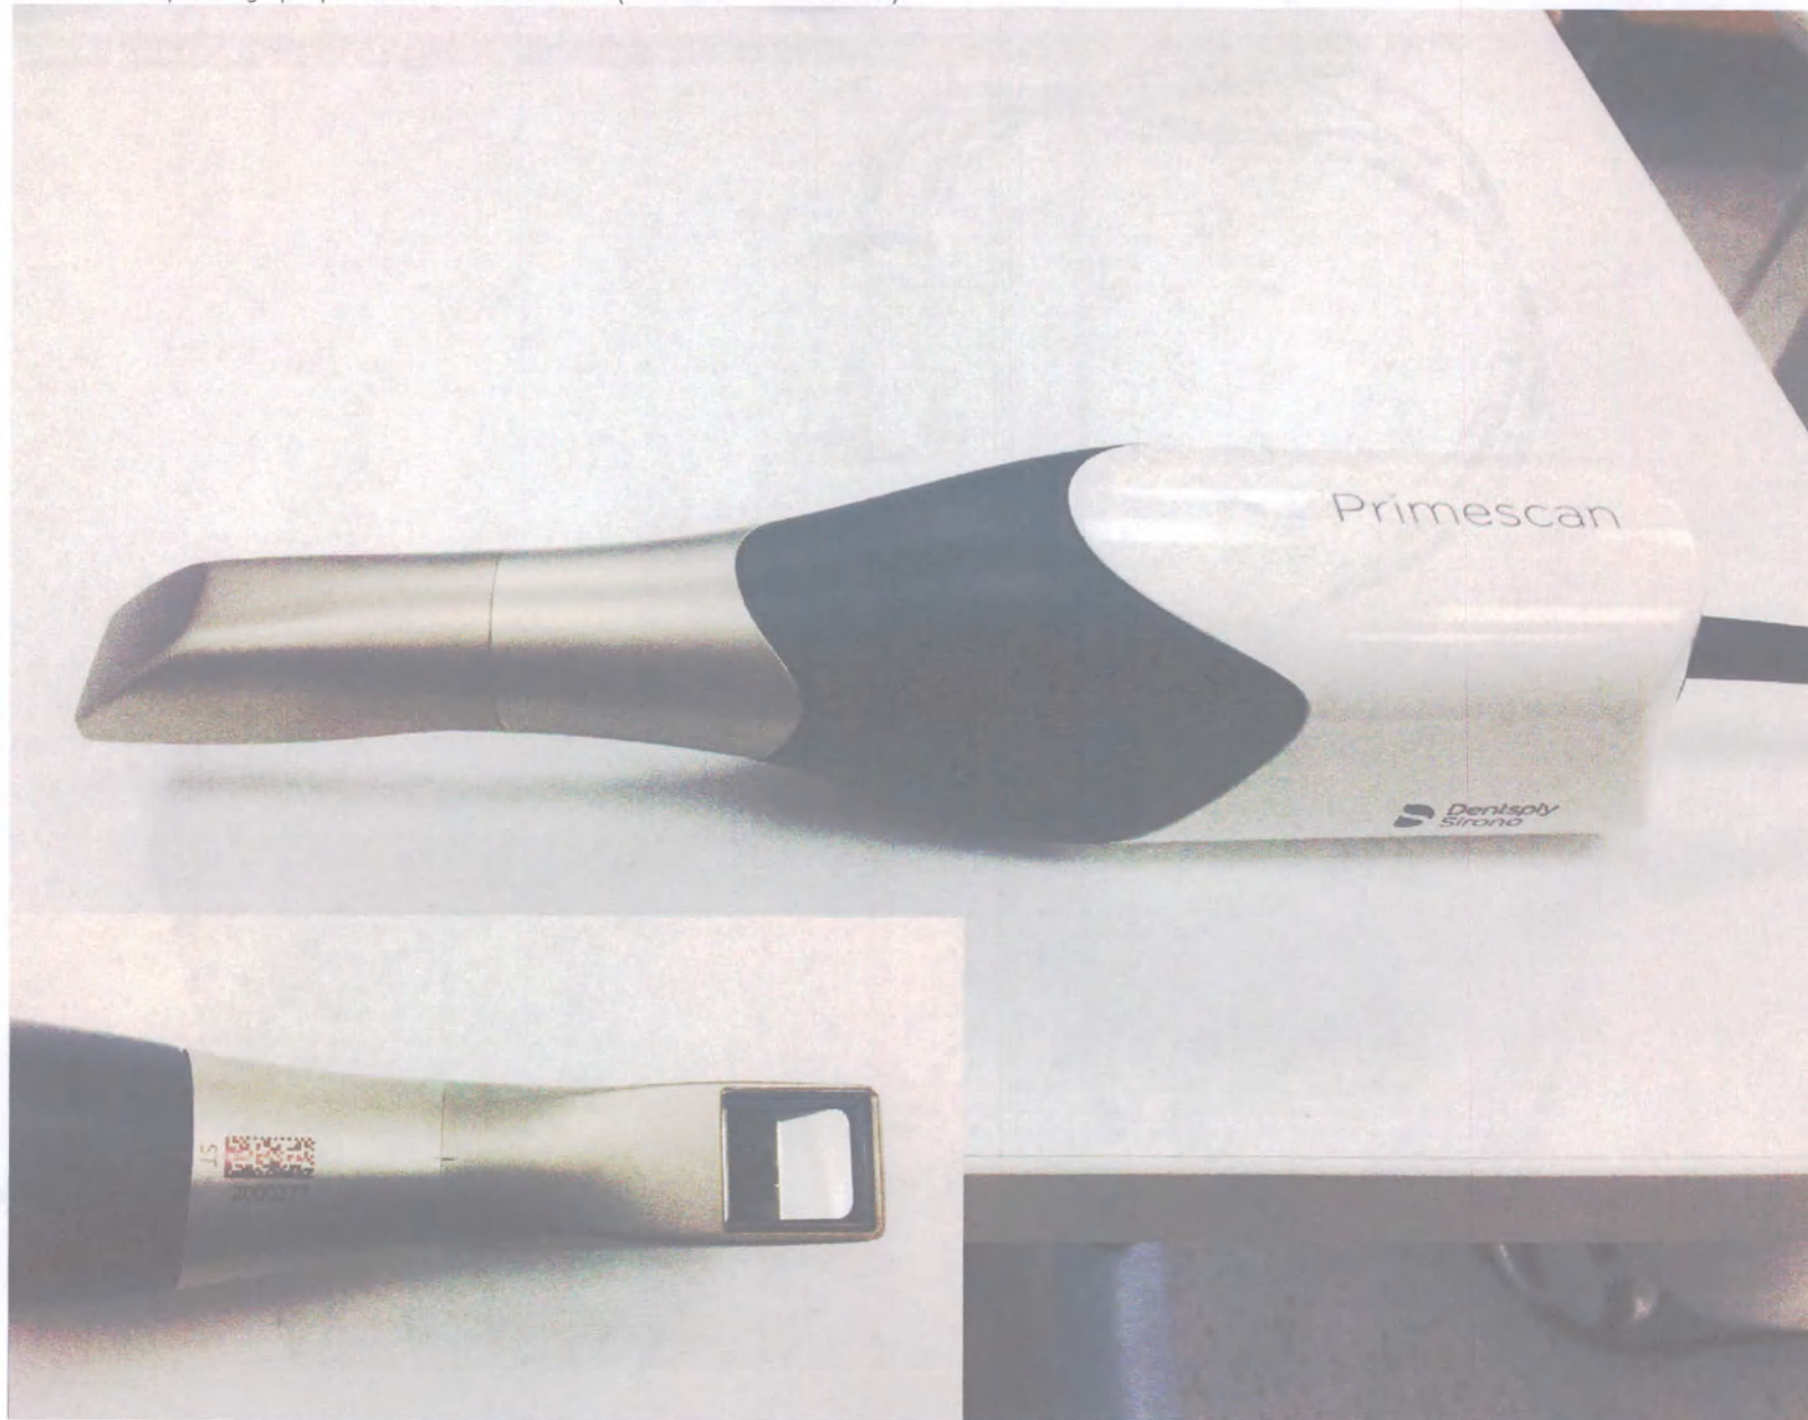

4. Кабель питания.





5. Насадка калибровочная для настройки точности.




6. Насадка калибровочная для настройки цвета.




7. Наконечник для камеры металлический Primescan. 7.1. с несъемным стеклом




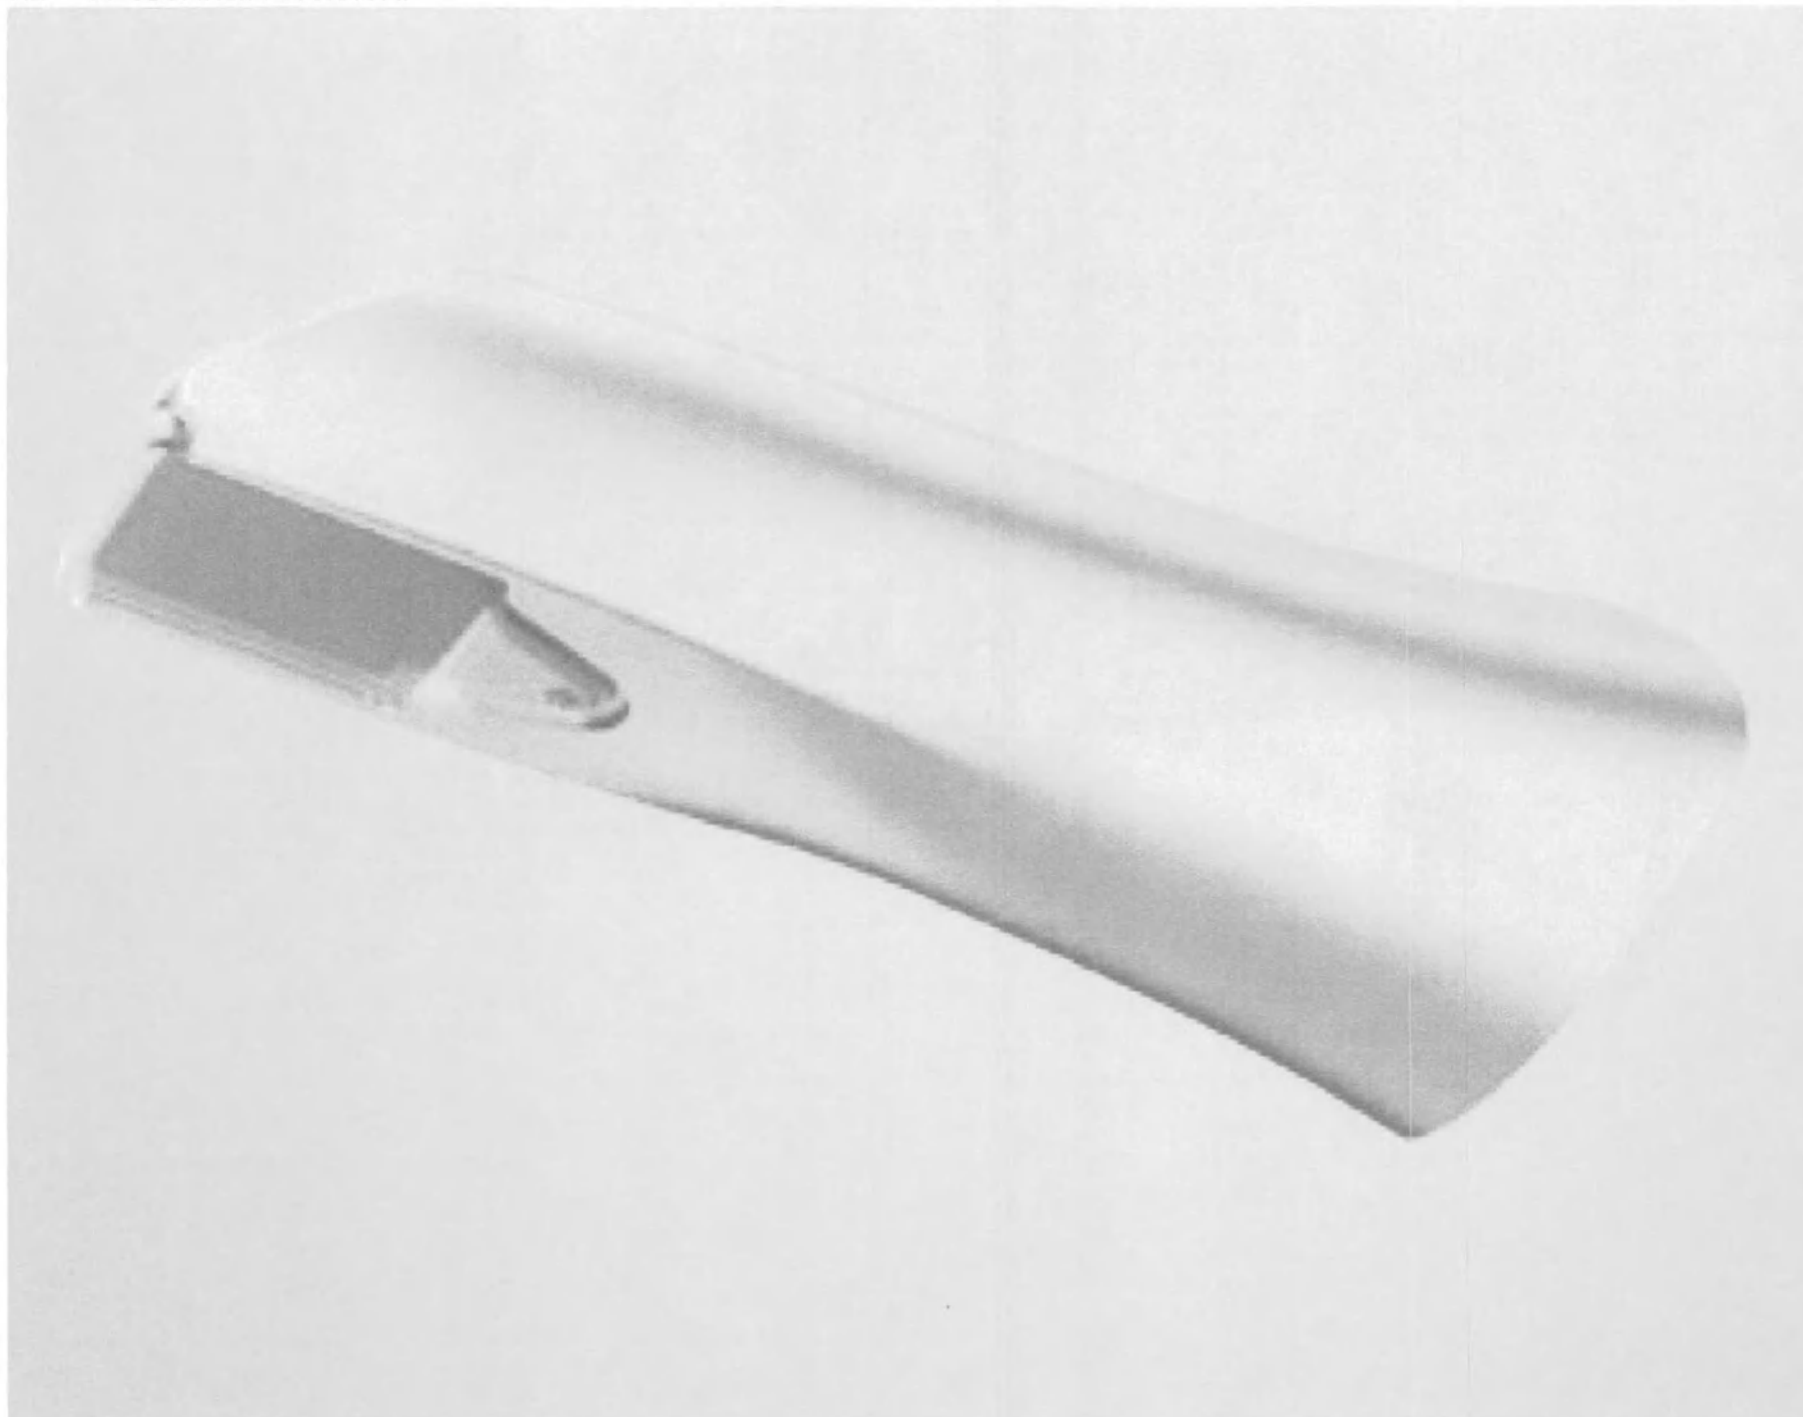


8. Наконечник одноразовый для камеры Primescan

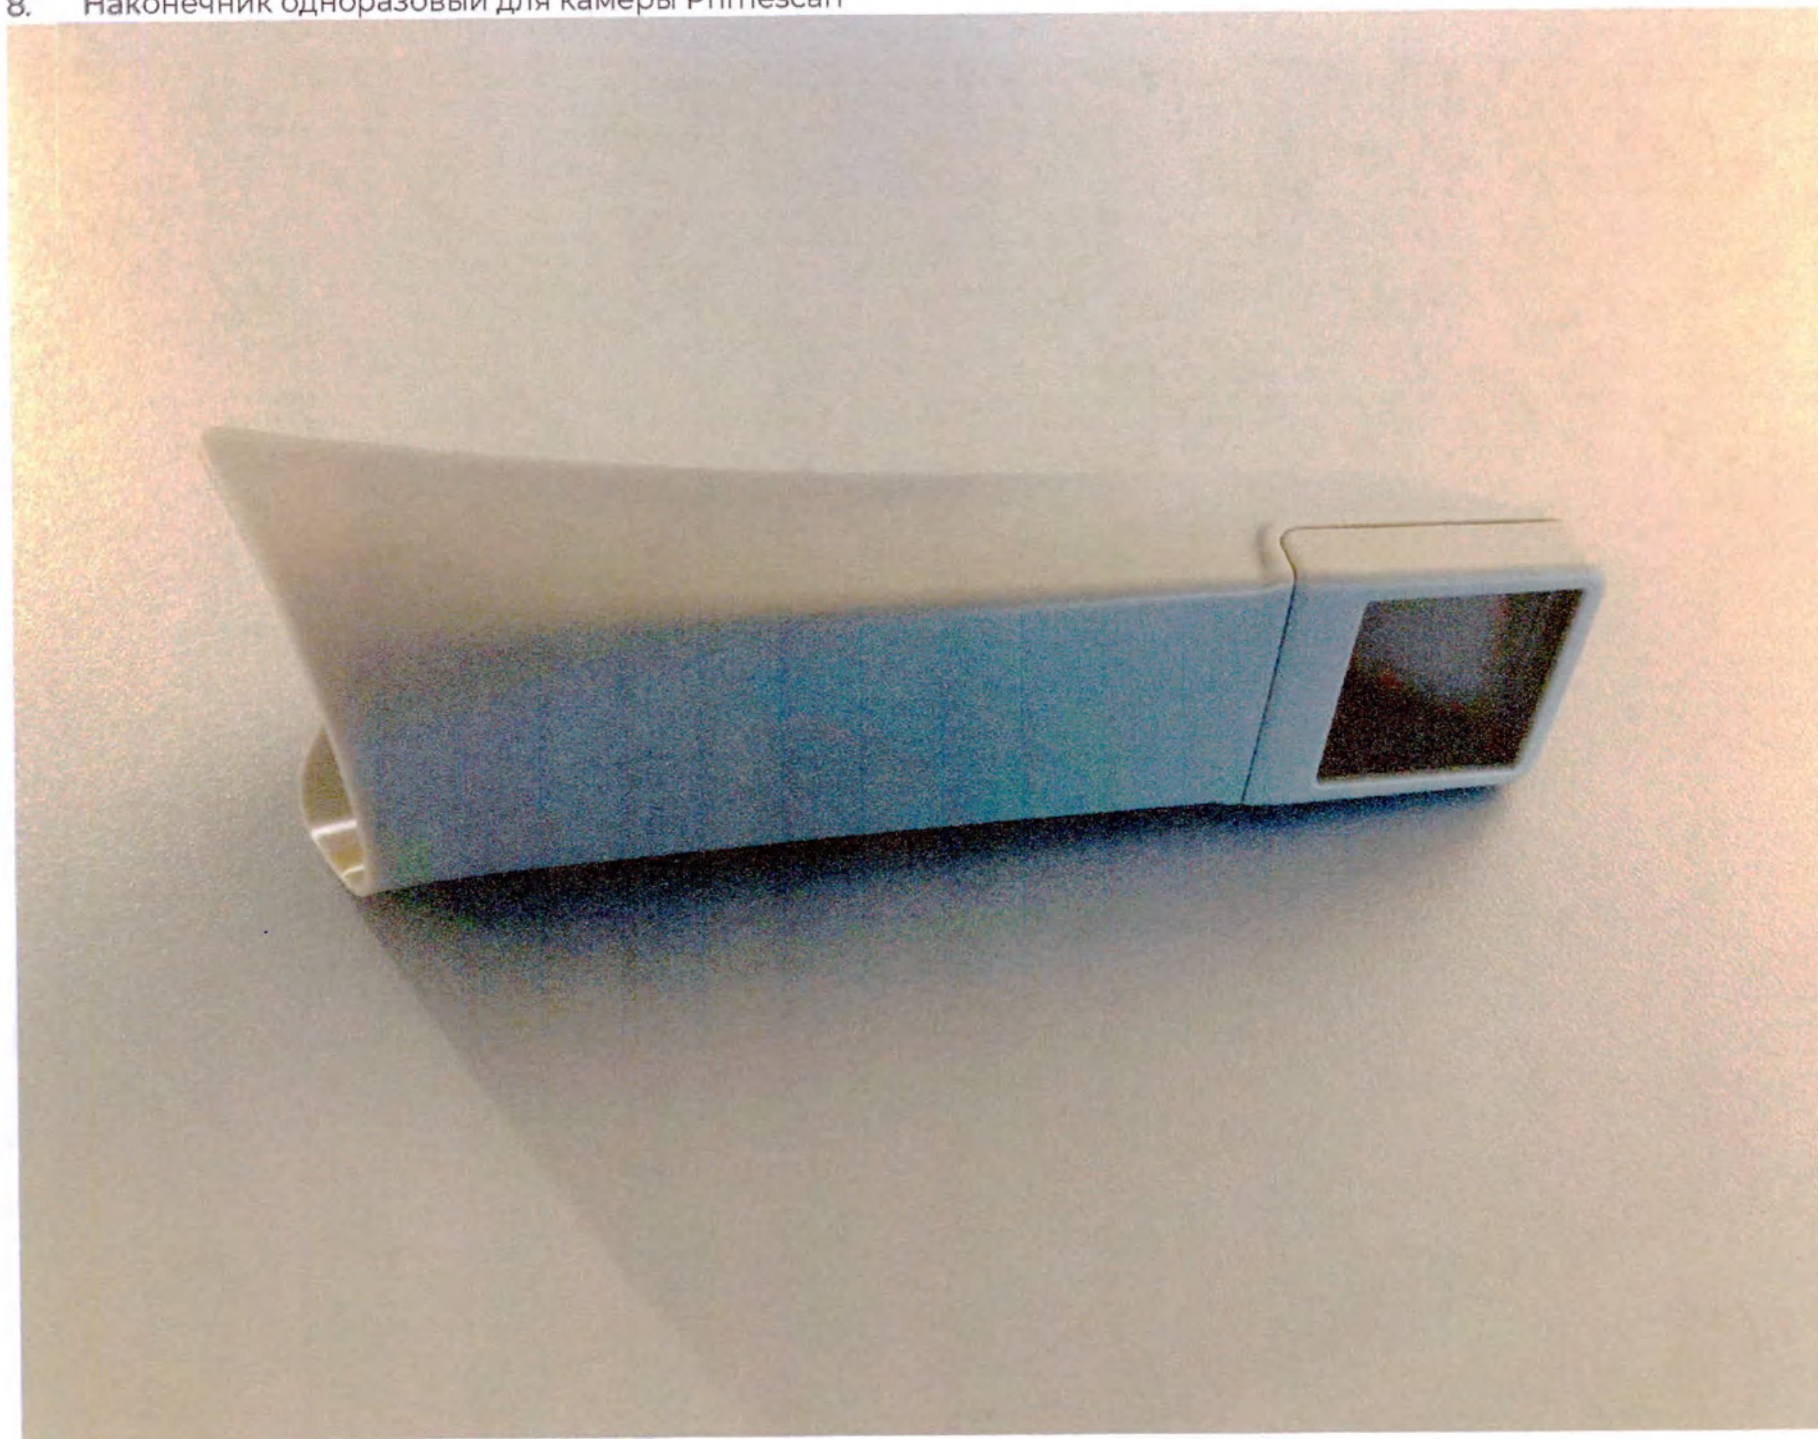

9. Заглушка пластиковая для камеры.

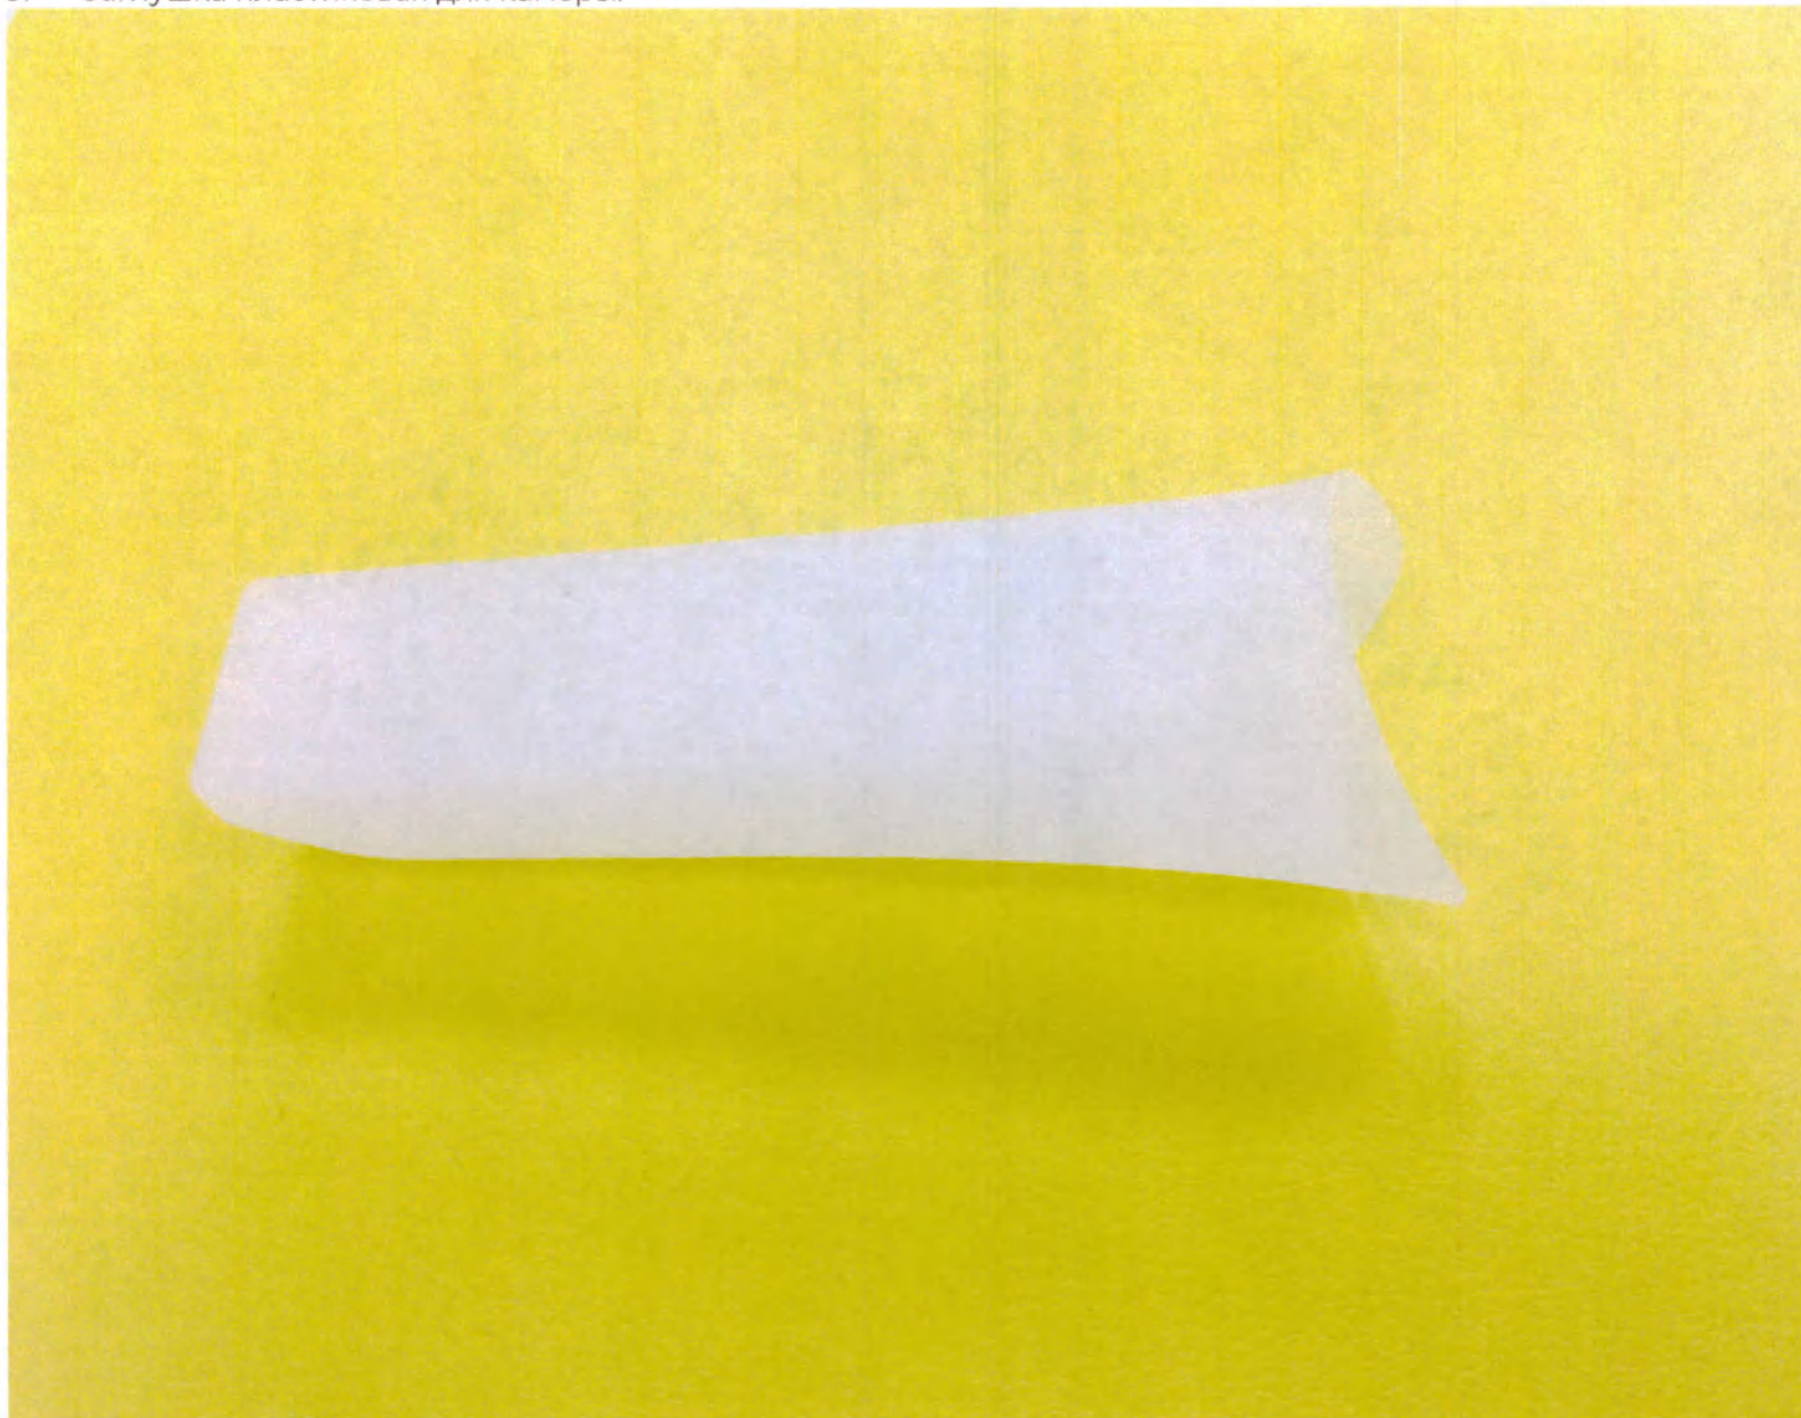

10. USB носитель с программными лицензиями.

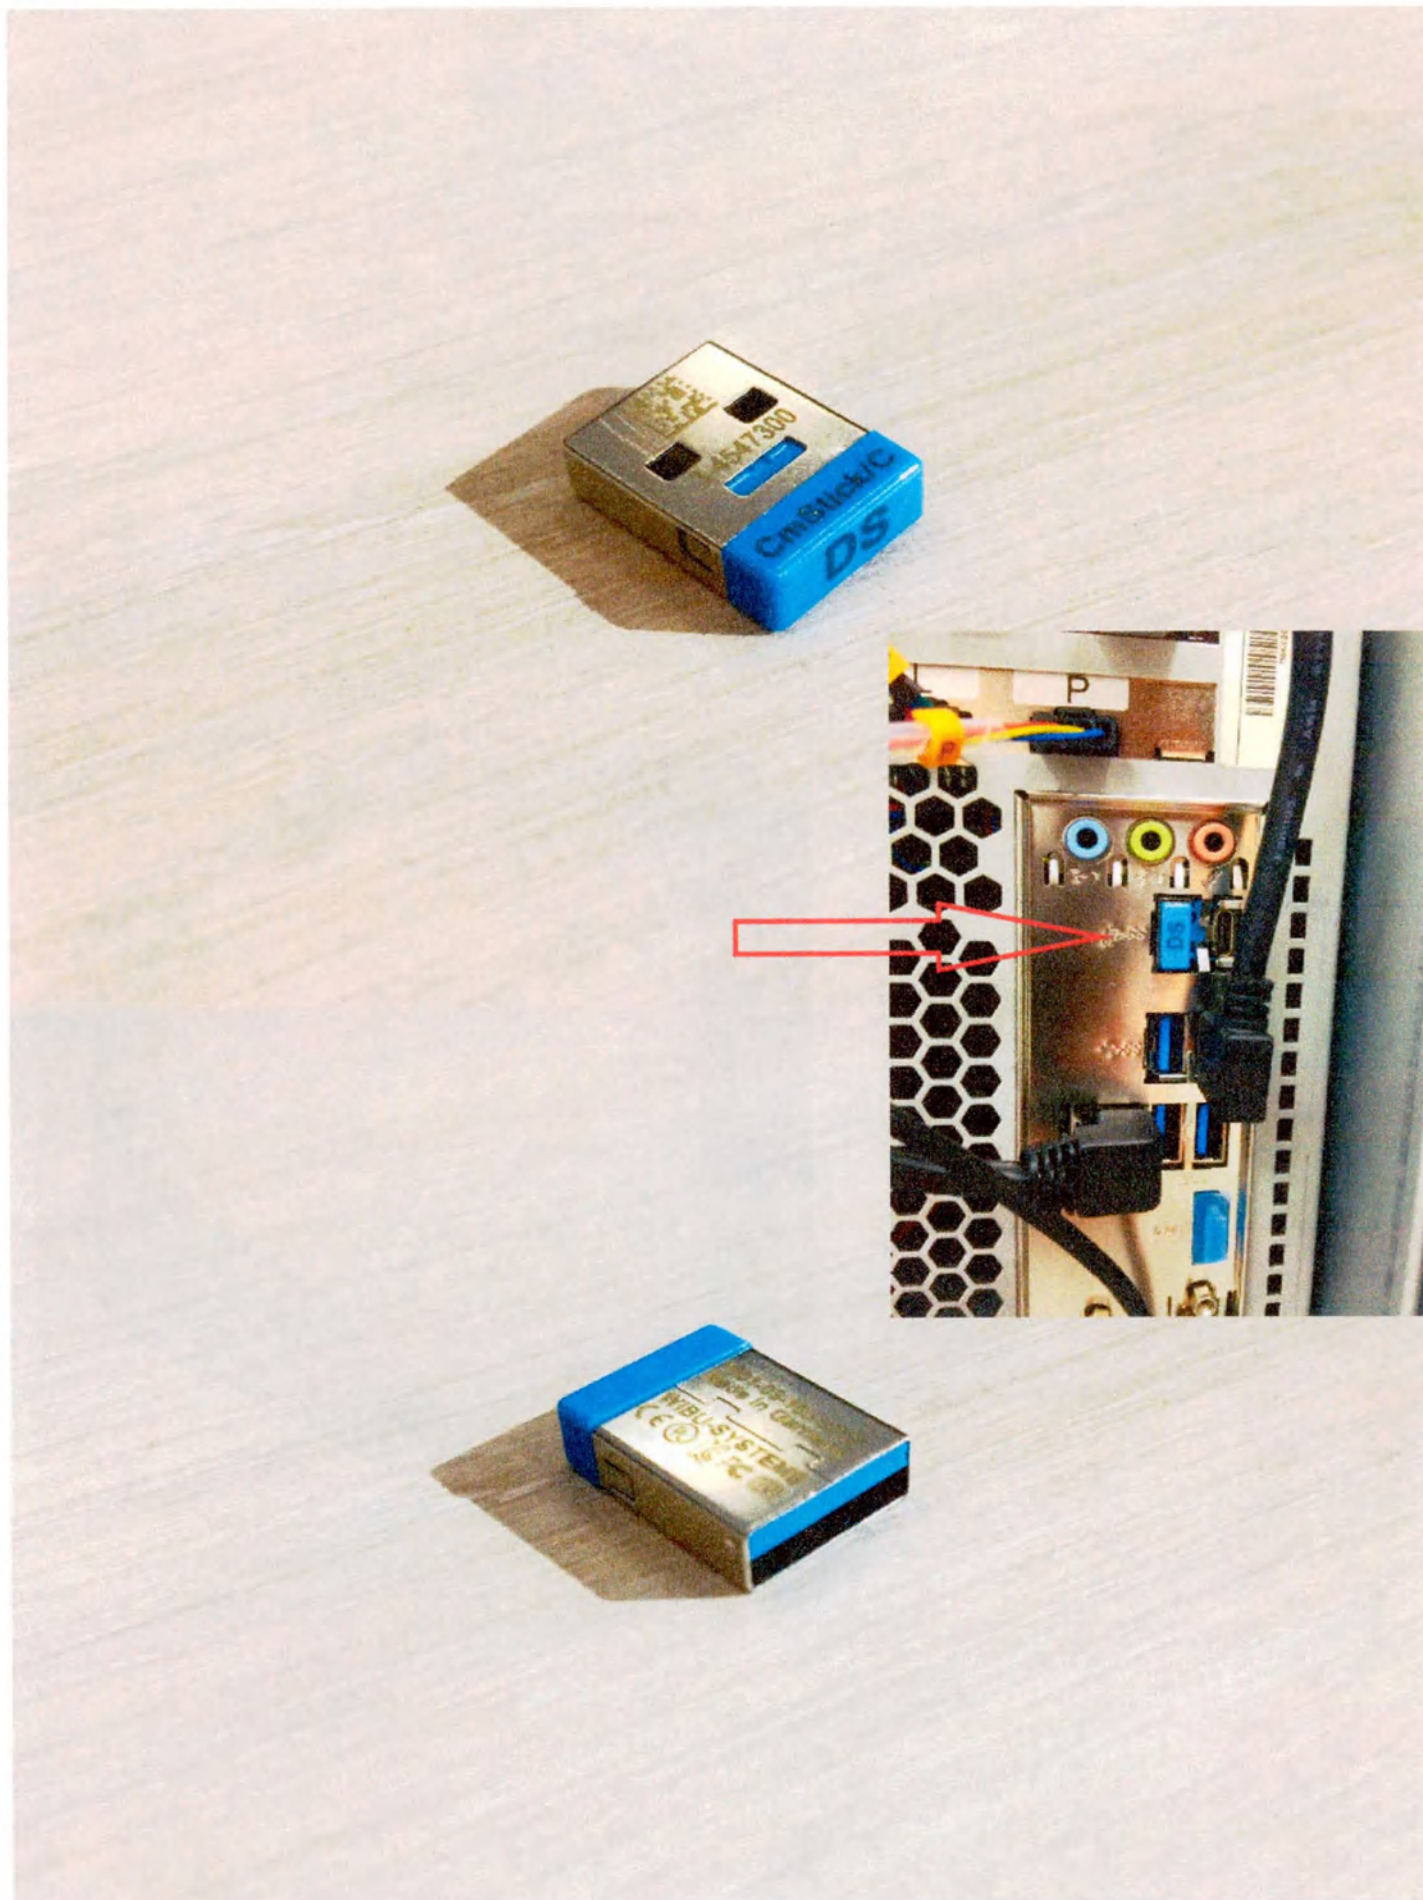

11. Фантом Модель челюсти.



12. Крепеж кабеля питания.




13. Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.



14. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе.



15. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера

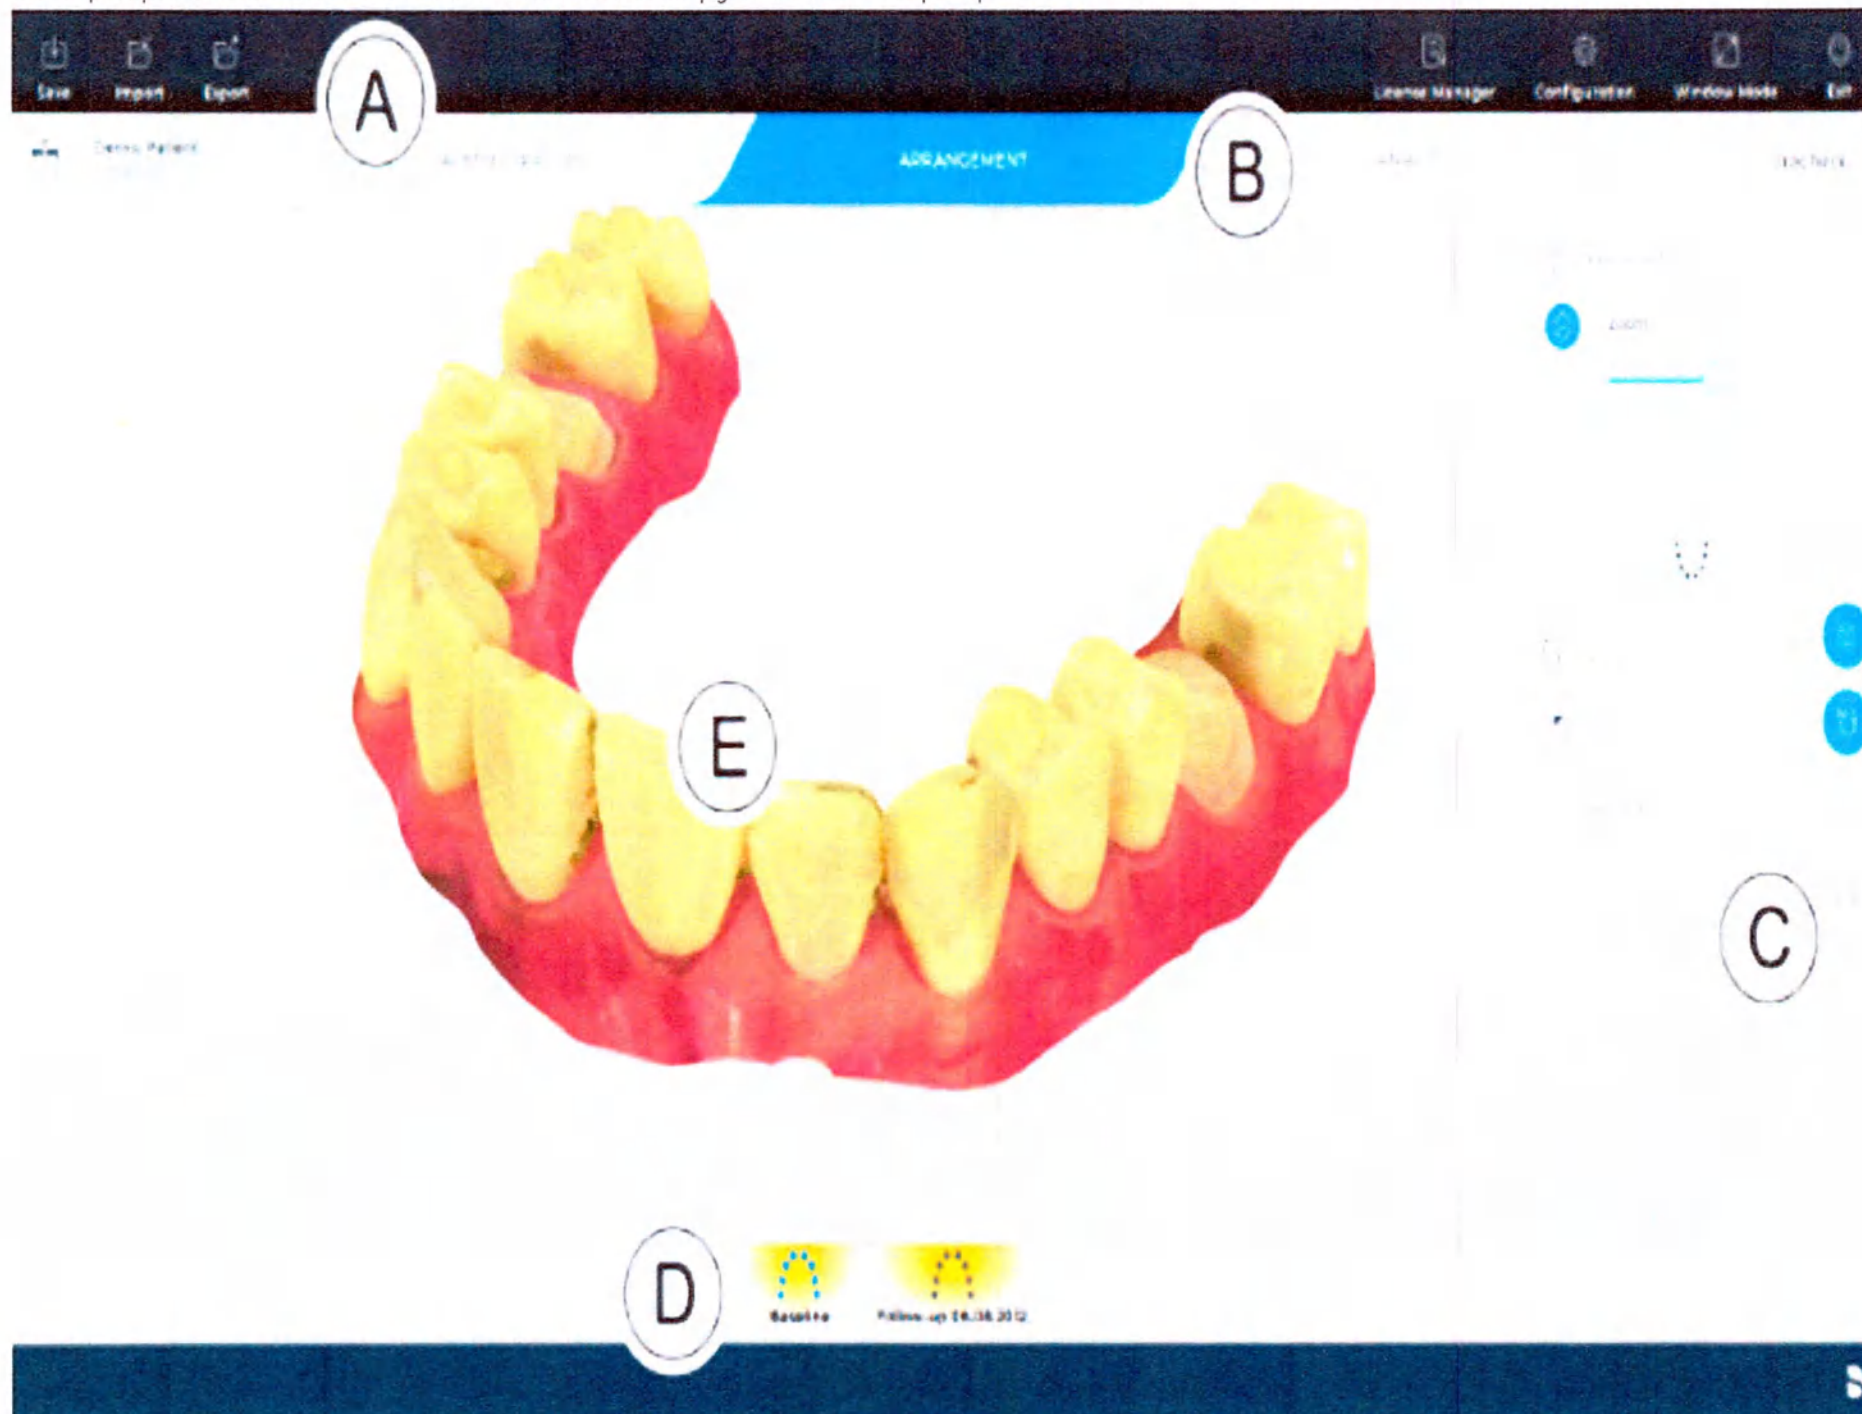

16. Лицензионные код| cense Voucher.




17. Винт крепеж для аккумулятора



18. Эксплуатационная документация, в составе:
18.1. инструкция по эксплуатации


Действует с: 01.2019




CEREC Primescan AC, Primescan AC

Инструкция по эксплуатации

Русский

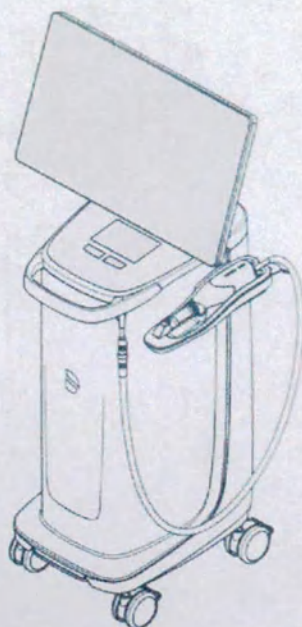

New as of: 09.2018




CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC


Unpacking and Installation Instructions

English





CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

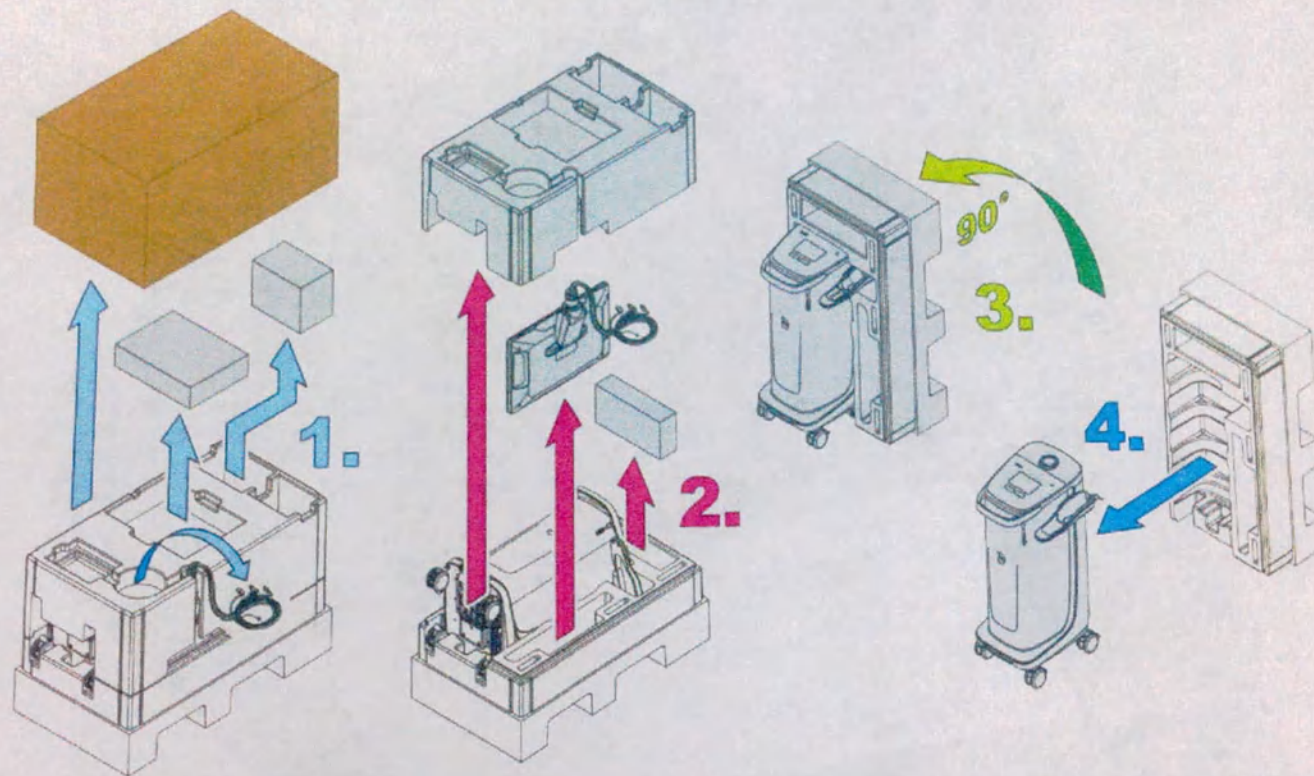

D3696.902.03.01.09 10.2018 A-Nr.: 000 000


67 00 608 D3696

Принадлежности:

1. Аккумулятор.



II. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Primescan AC:

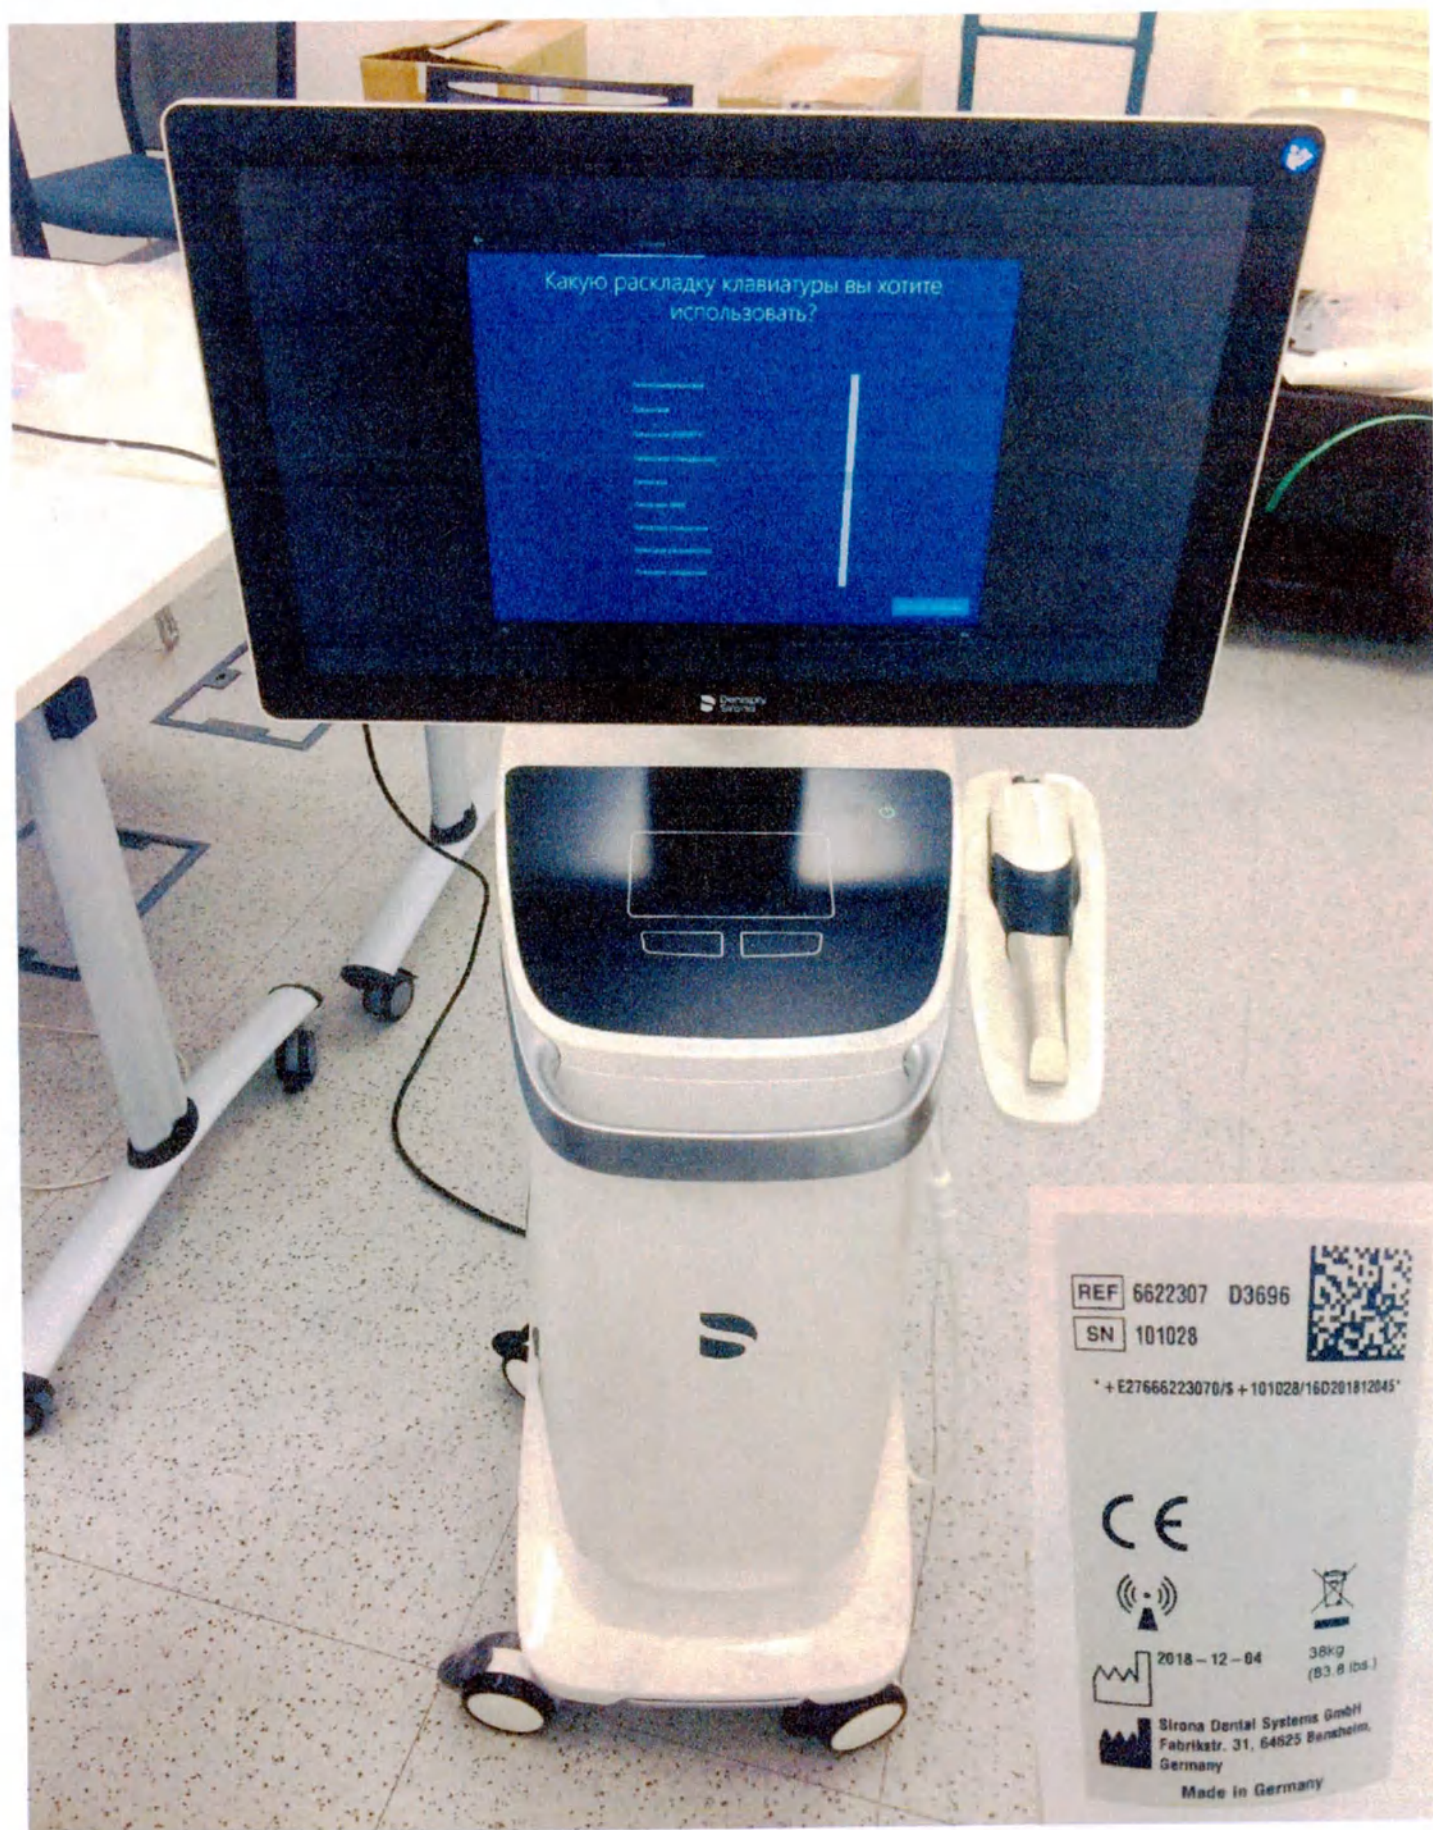


1. Блок для съемки с тандемом или блок для съемки с шаровым манипулятором.




2. Монитор.



3. Камера внутриротовая Primescan (CEREC Primescan).

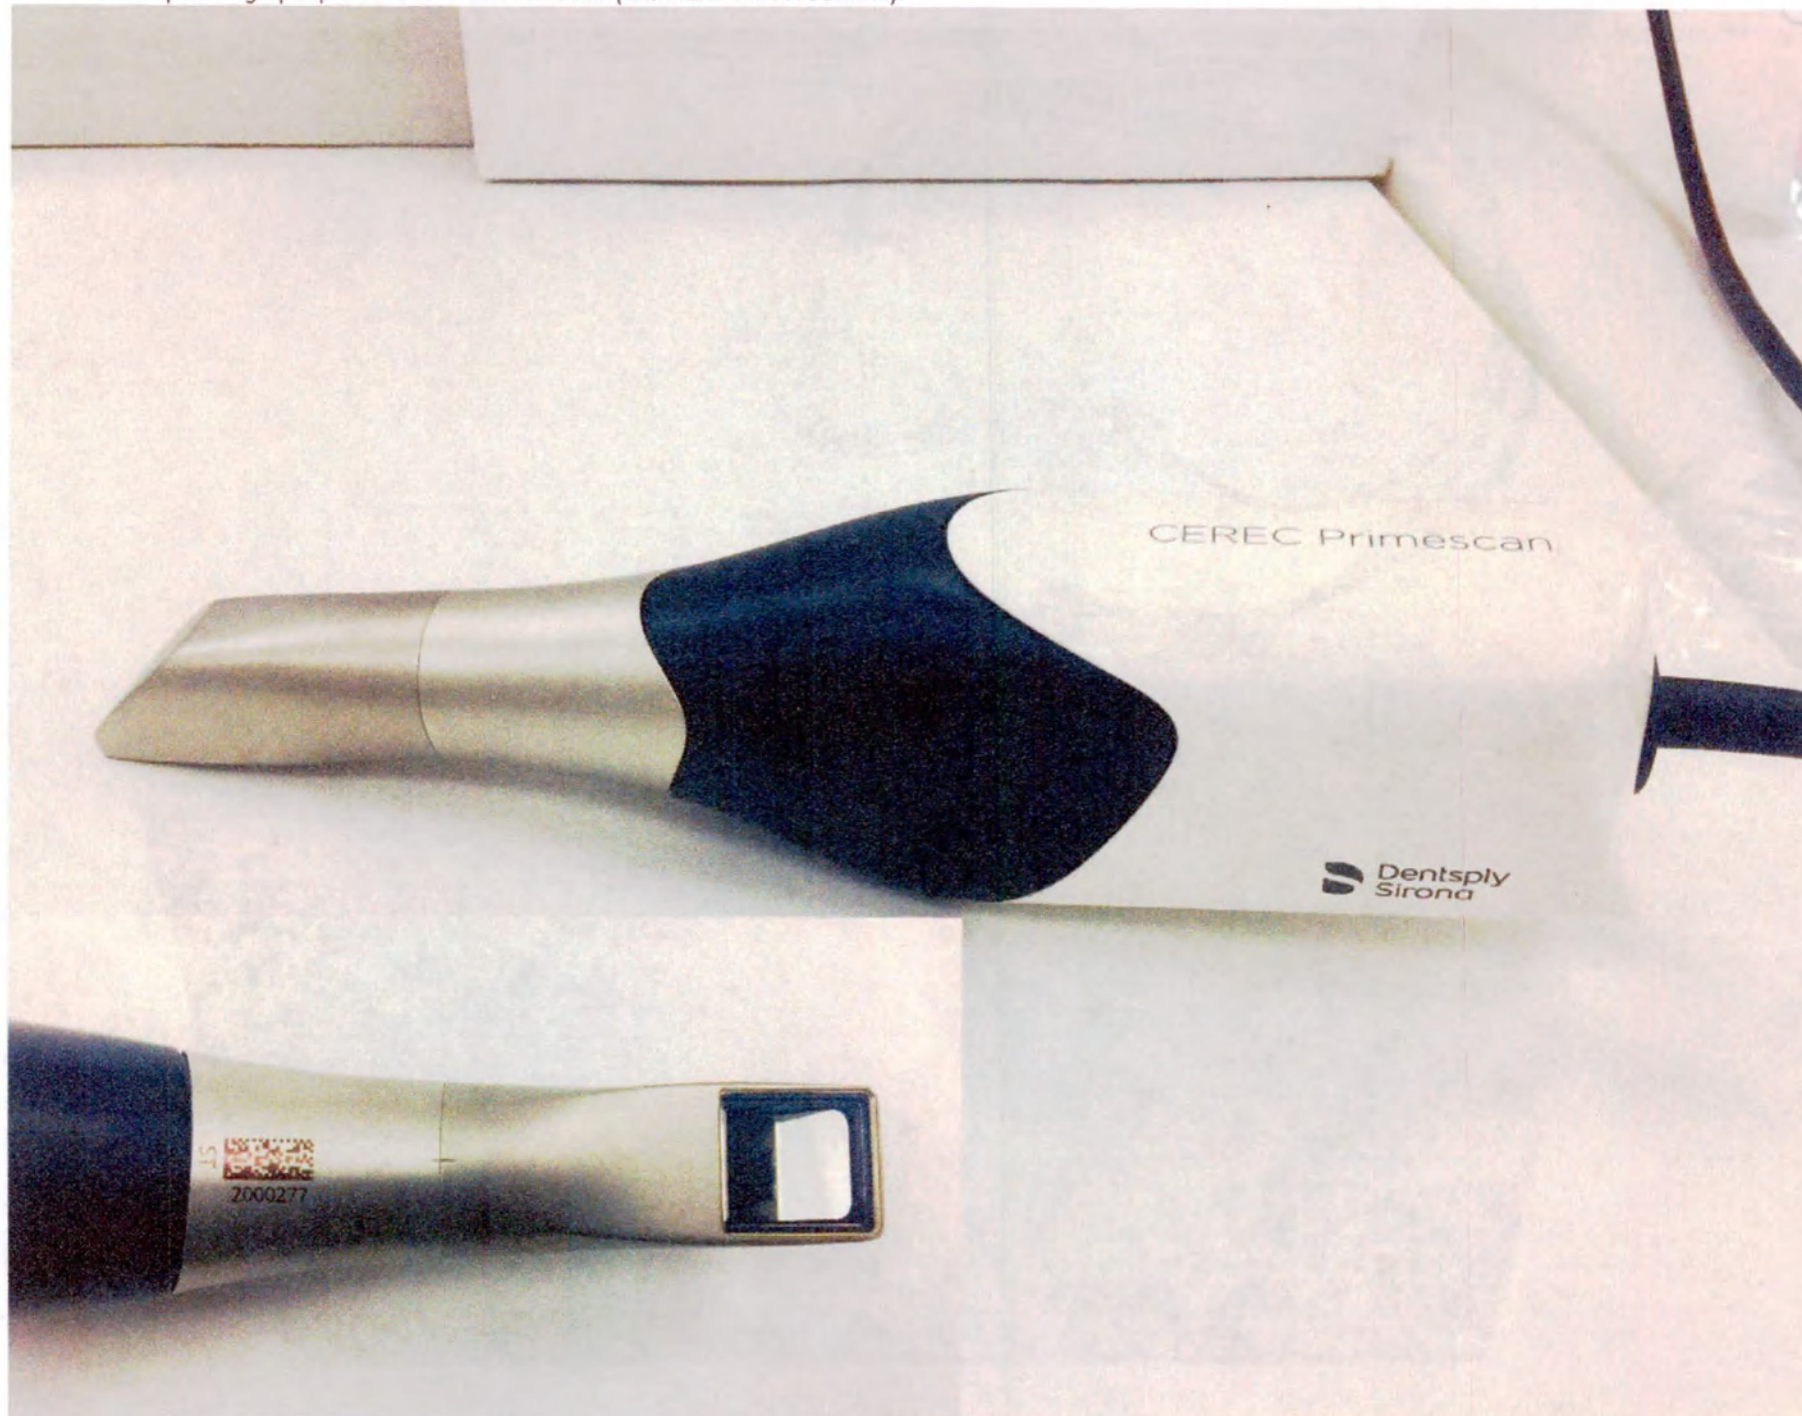

4. Кабель питания.

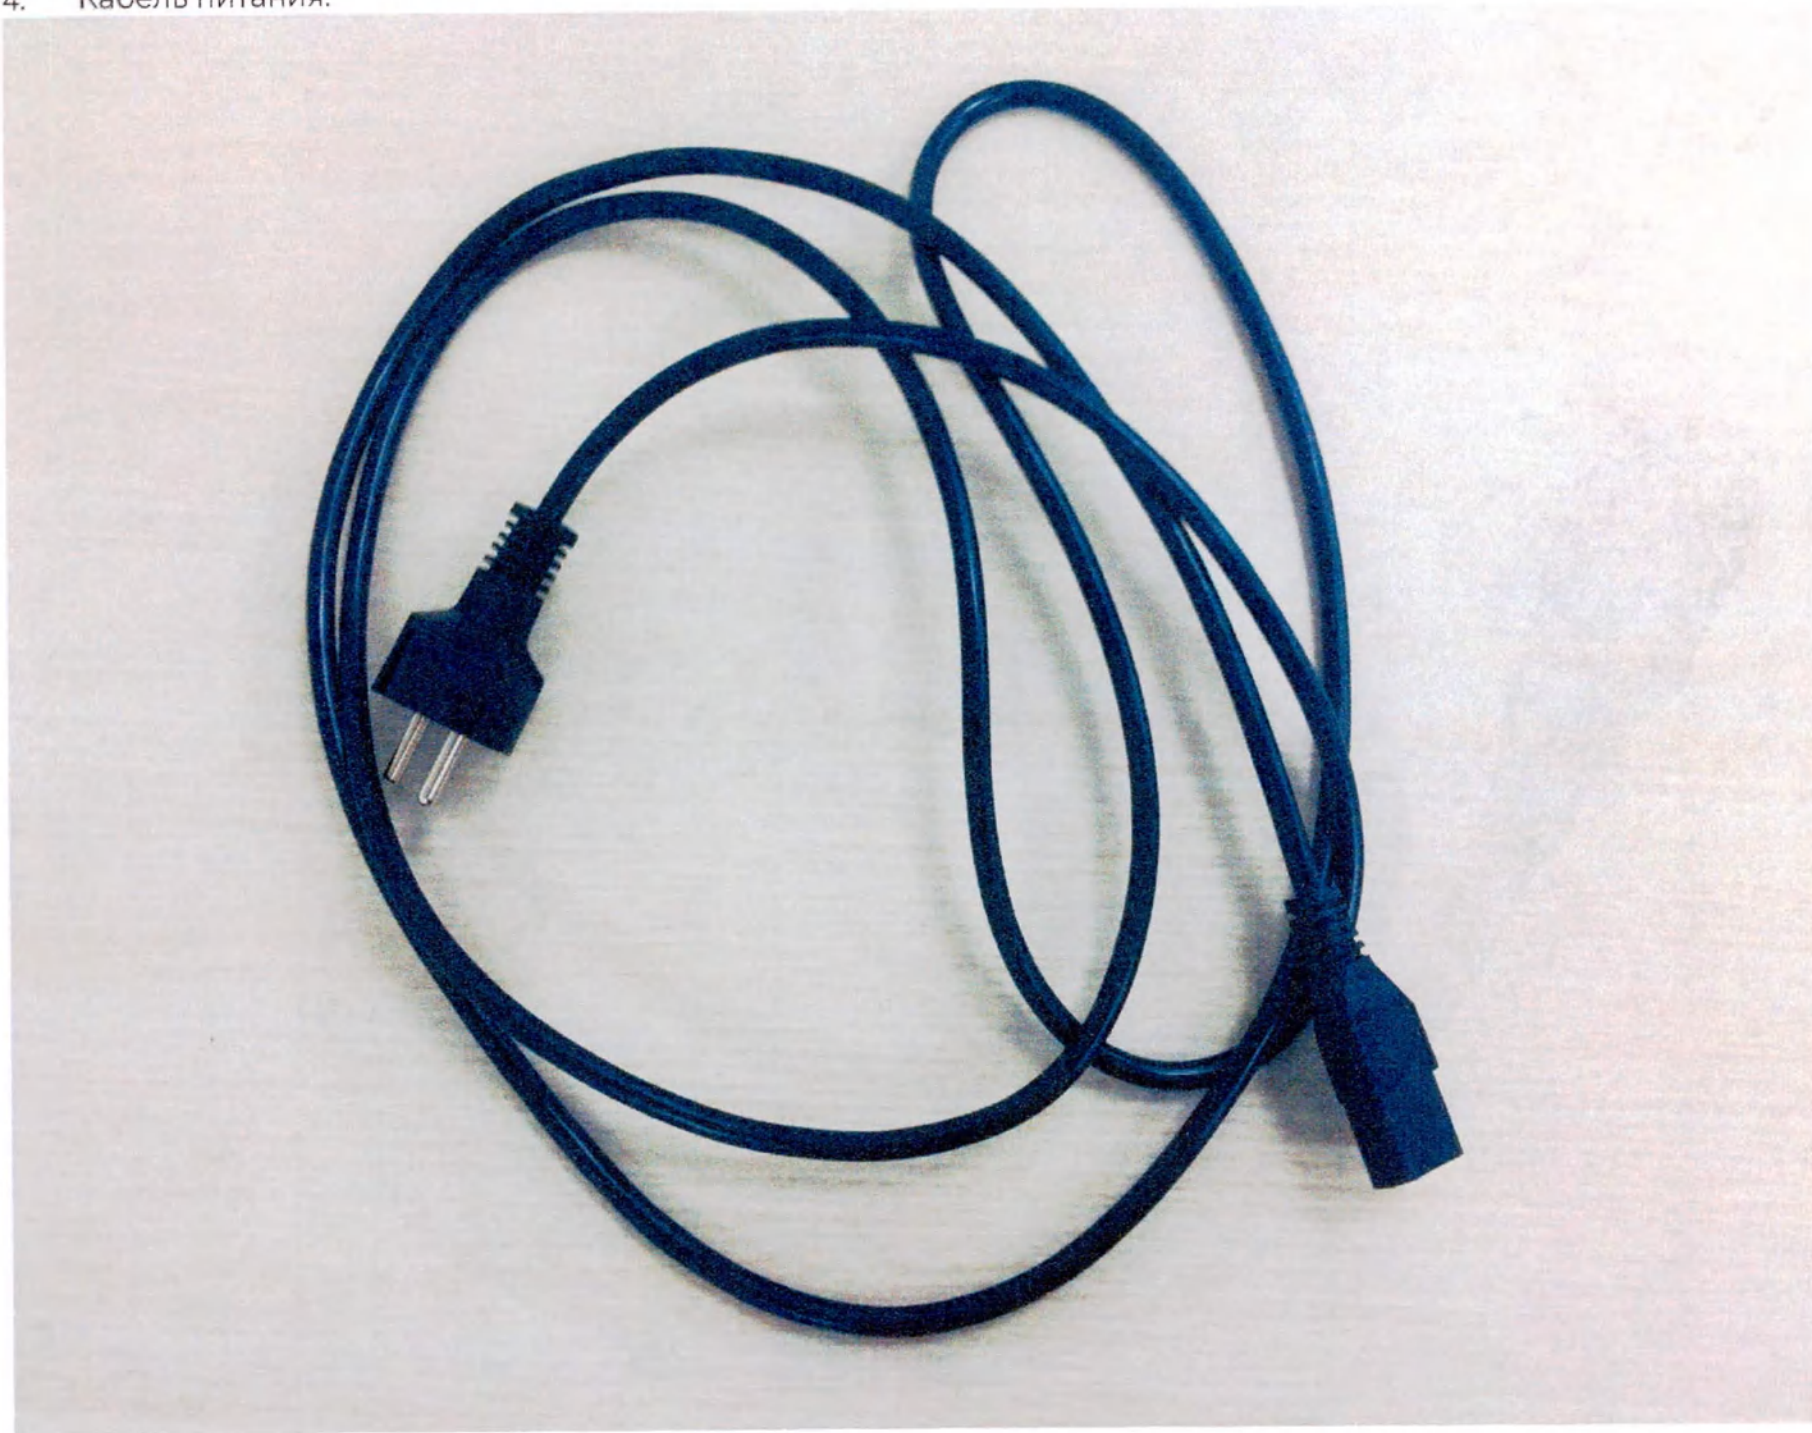



5. Насадка калибровочная для настройки точности.




6. Насадка калибровочная для настройки цвета.




7. Наконечник для камеры металлический Primescan. 7.1. с несъемным стеклом




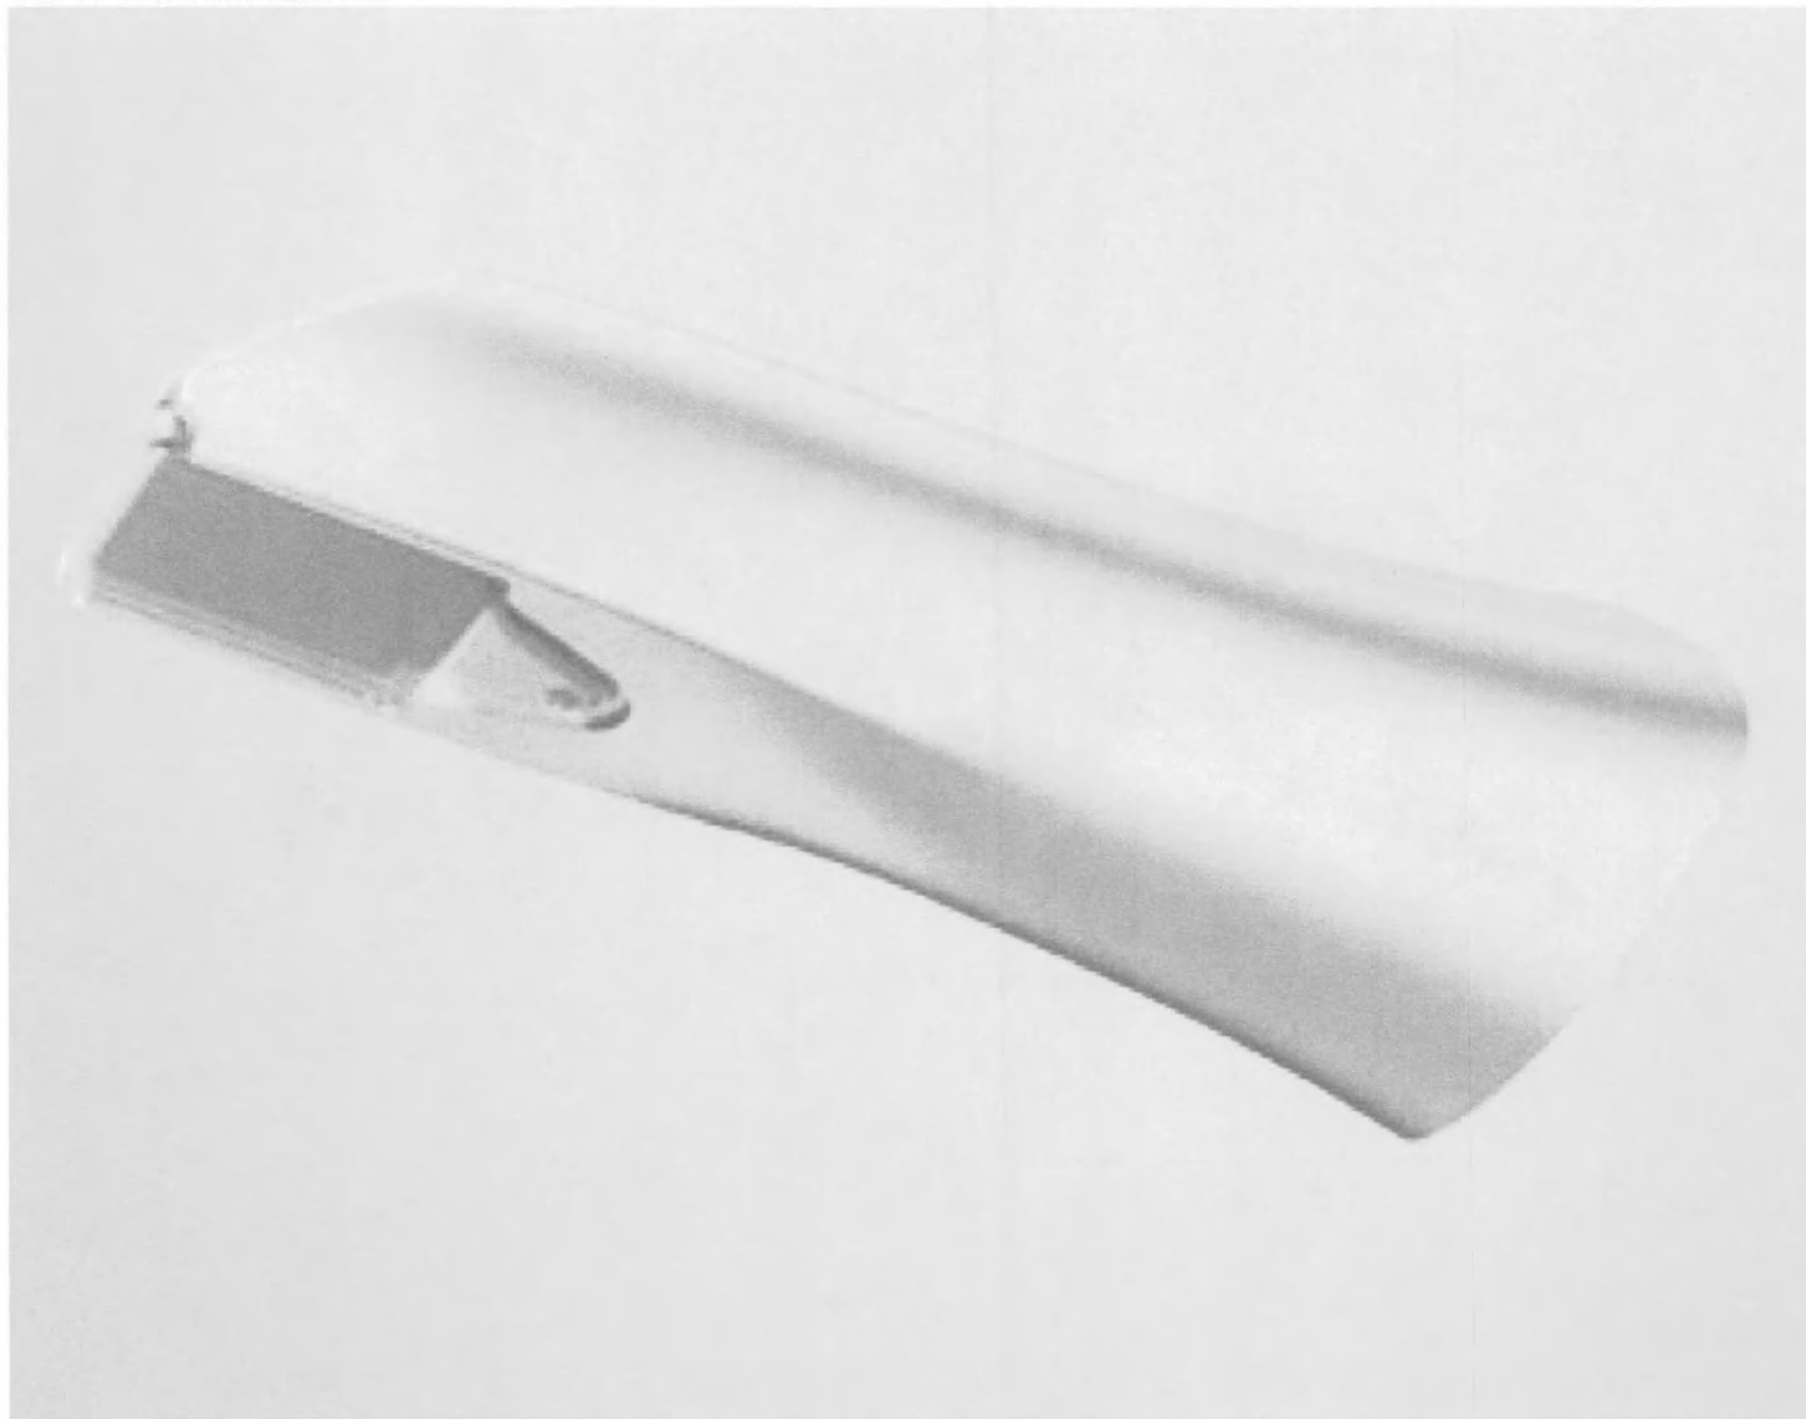


8. Наконечник одноразовый для камеры Primescan

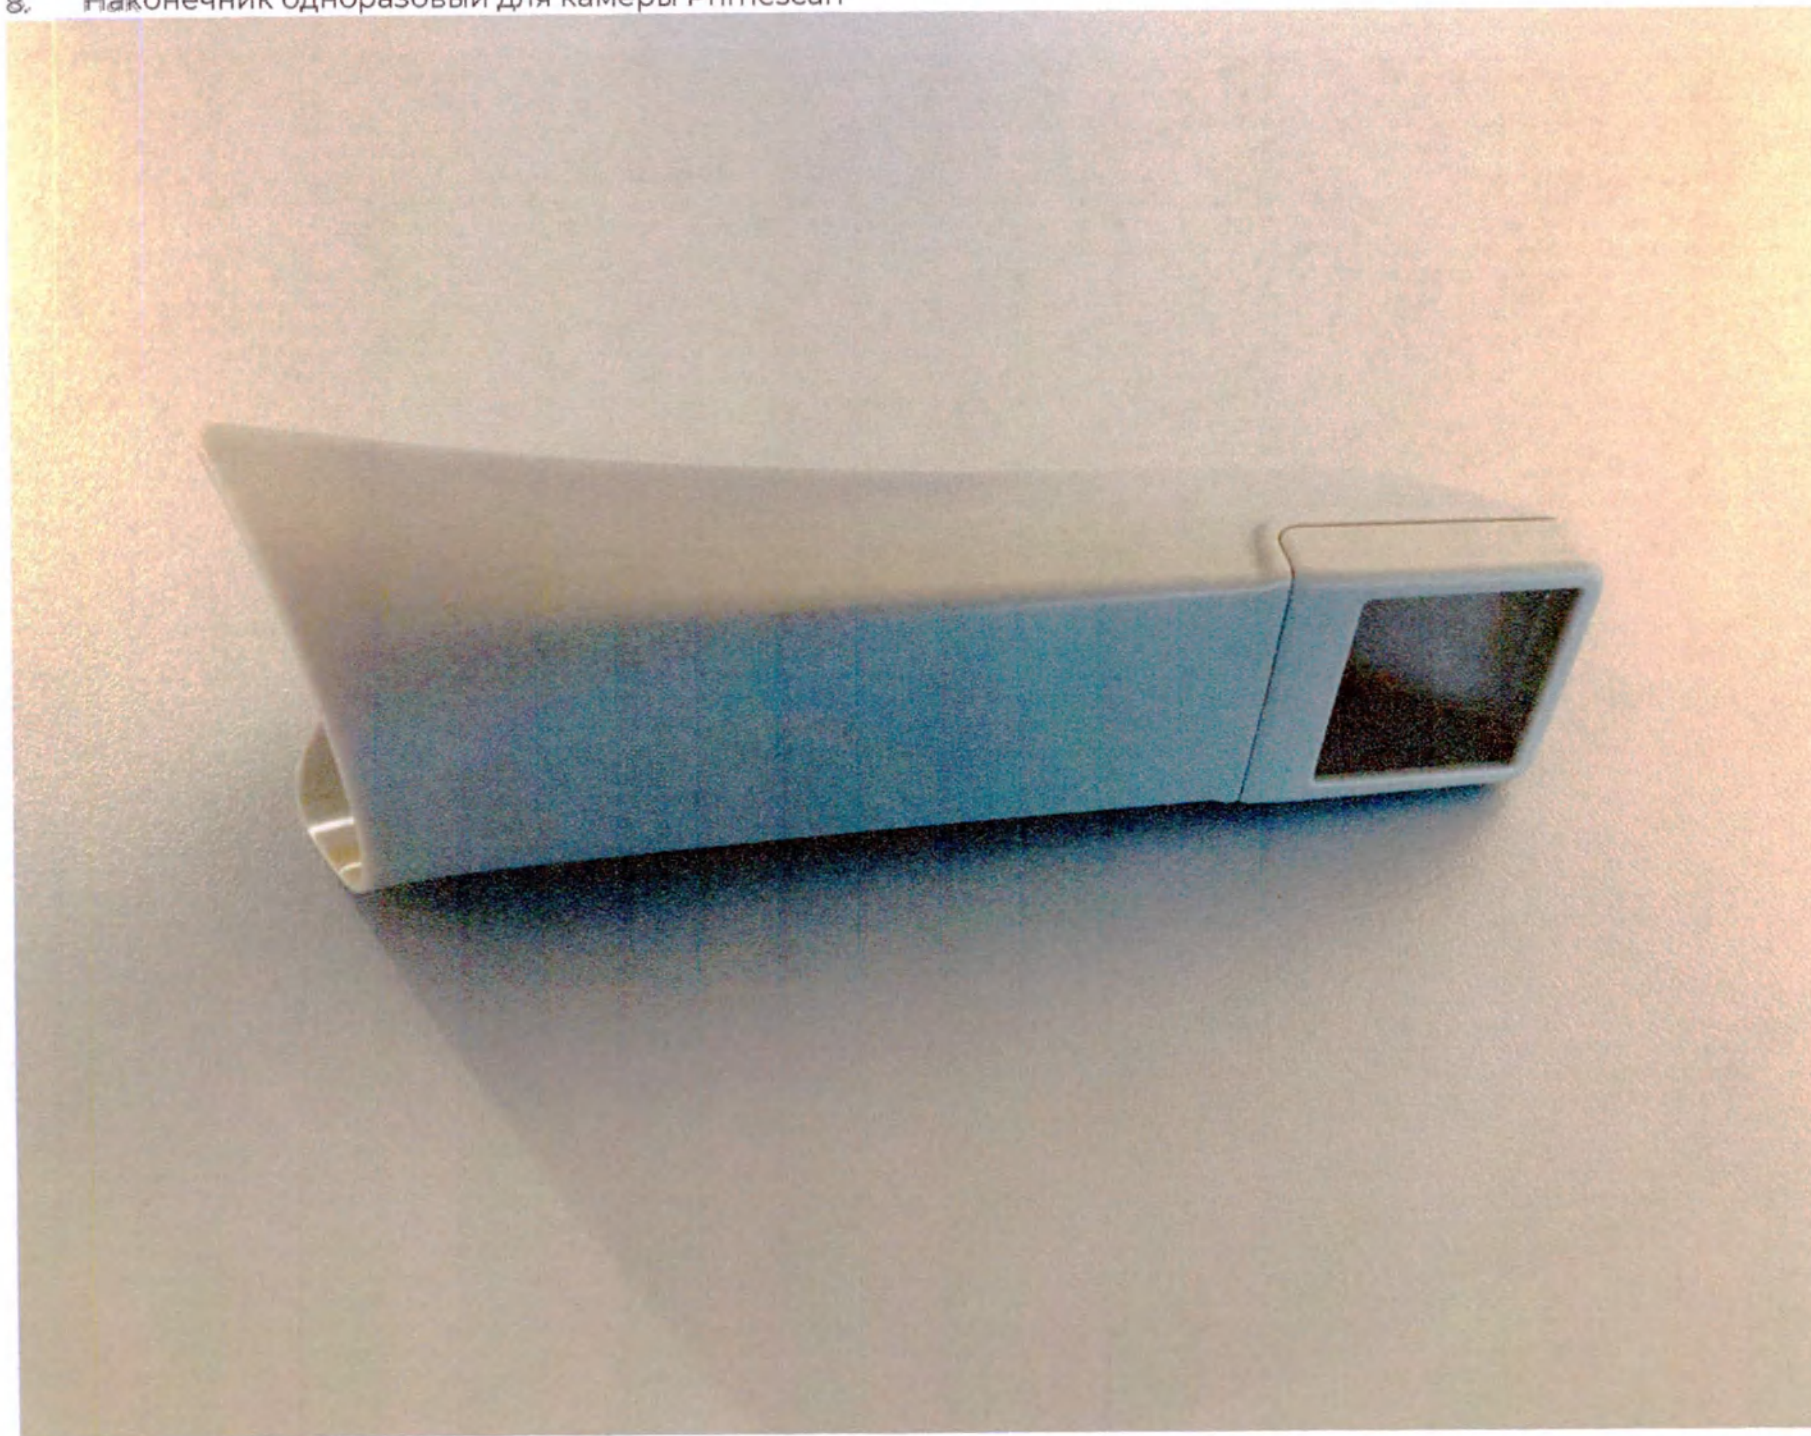

9. Заглушка пластиковая для камеры.

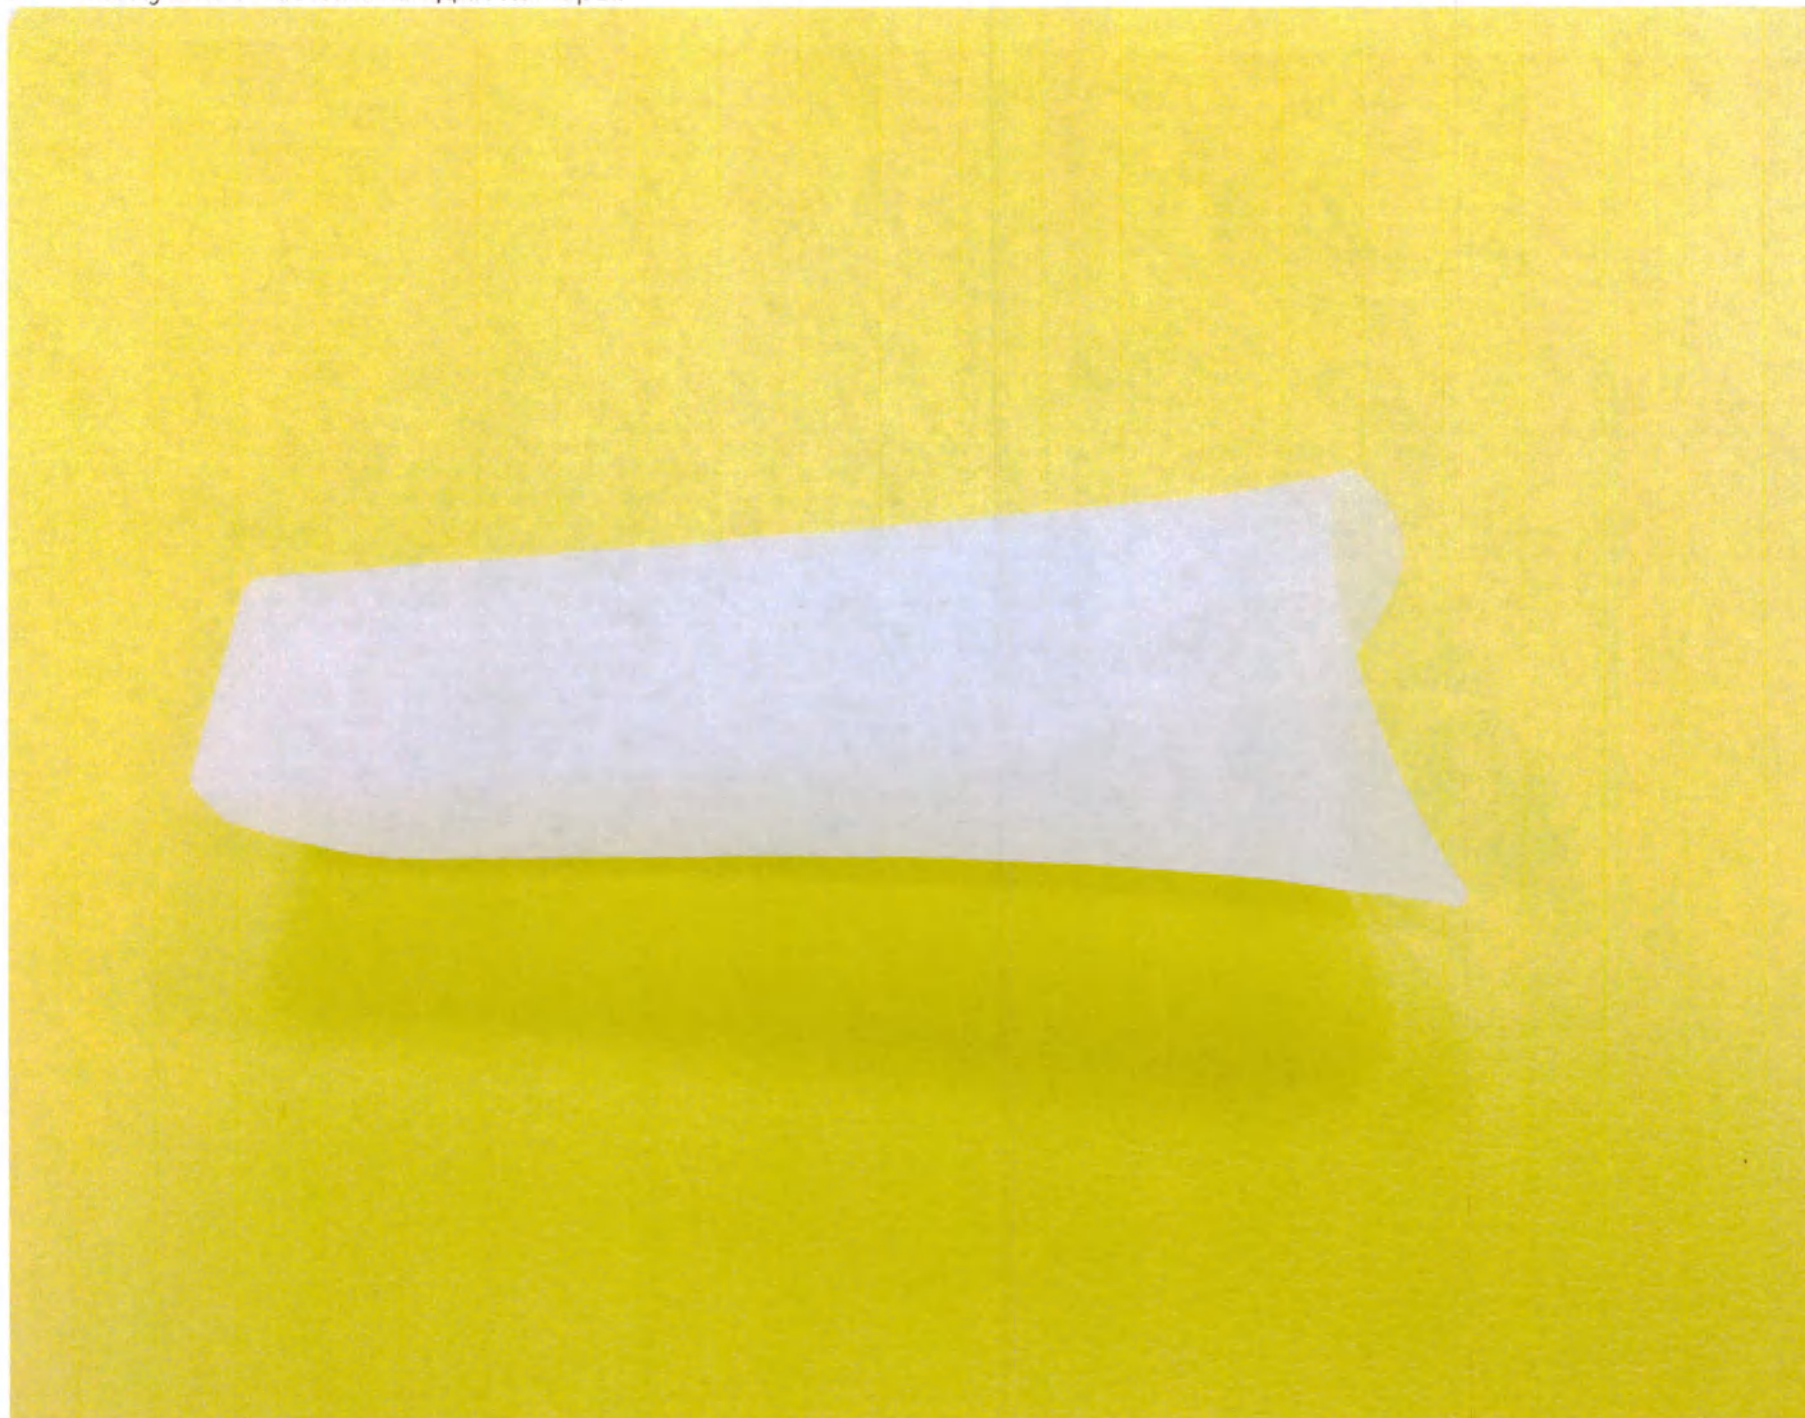


10. USB носитель с программными лицензиями.

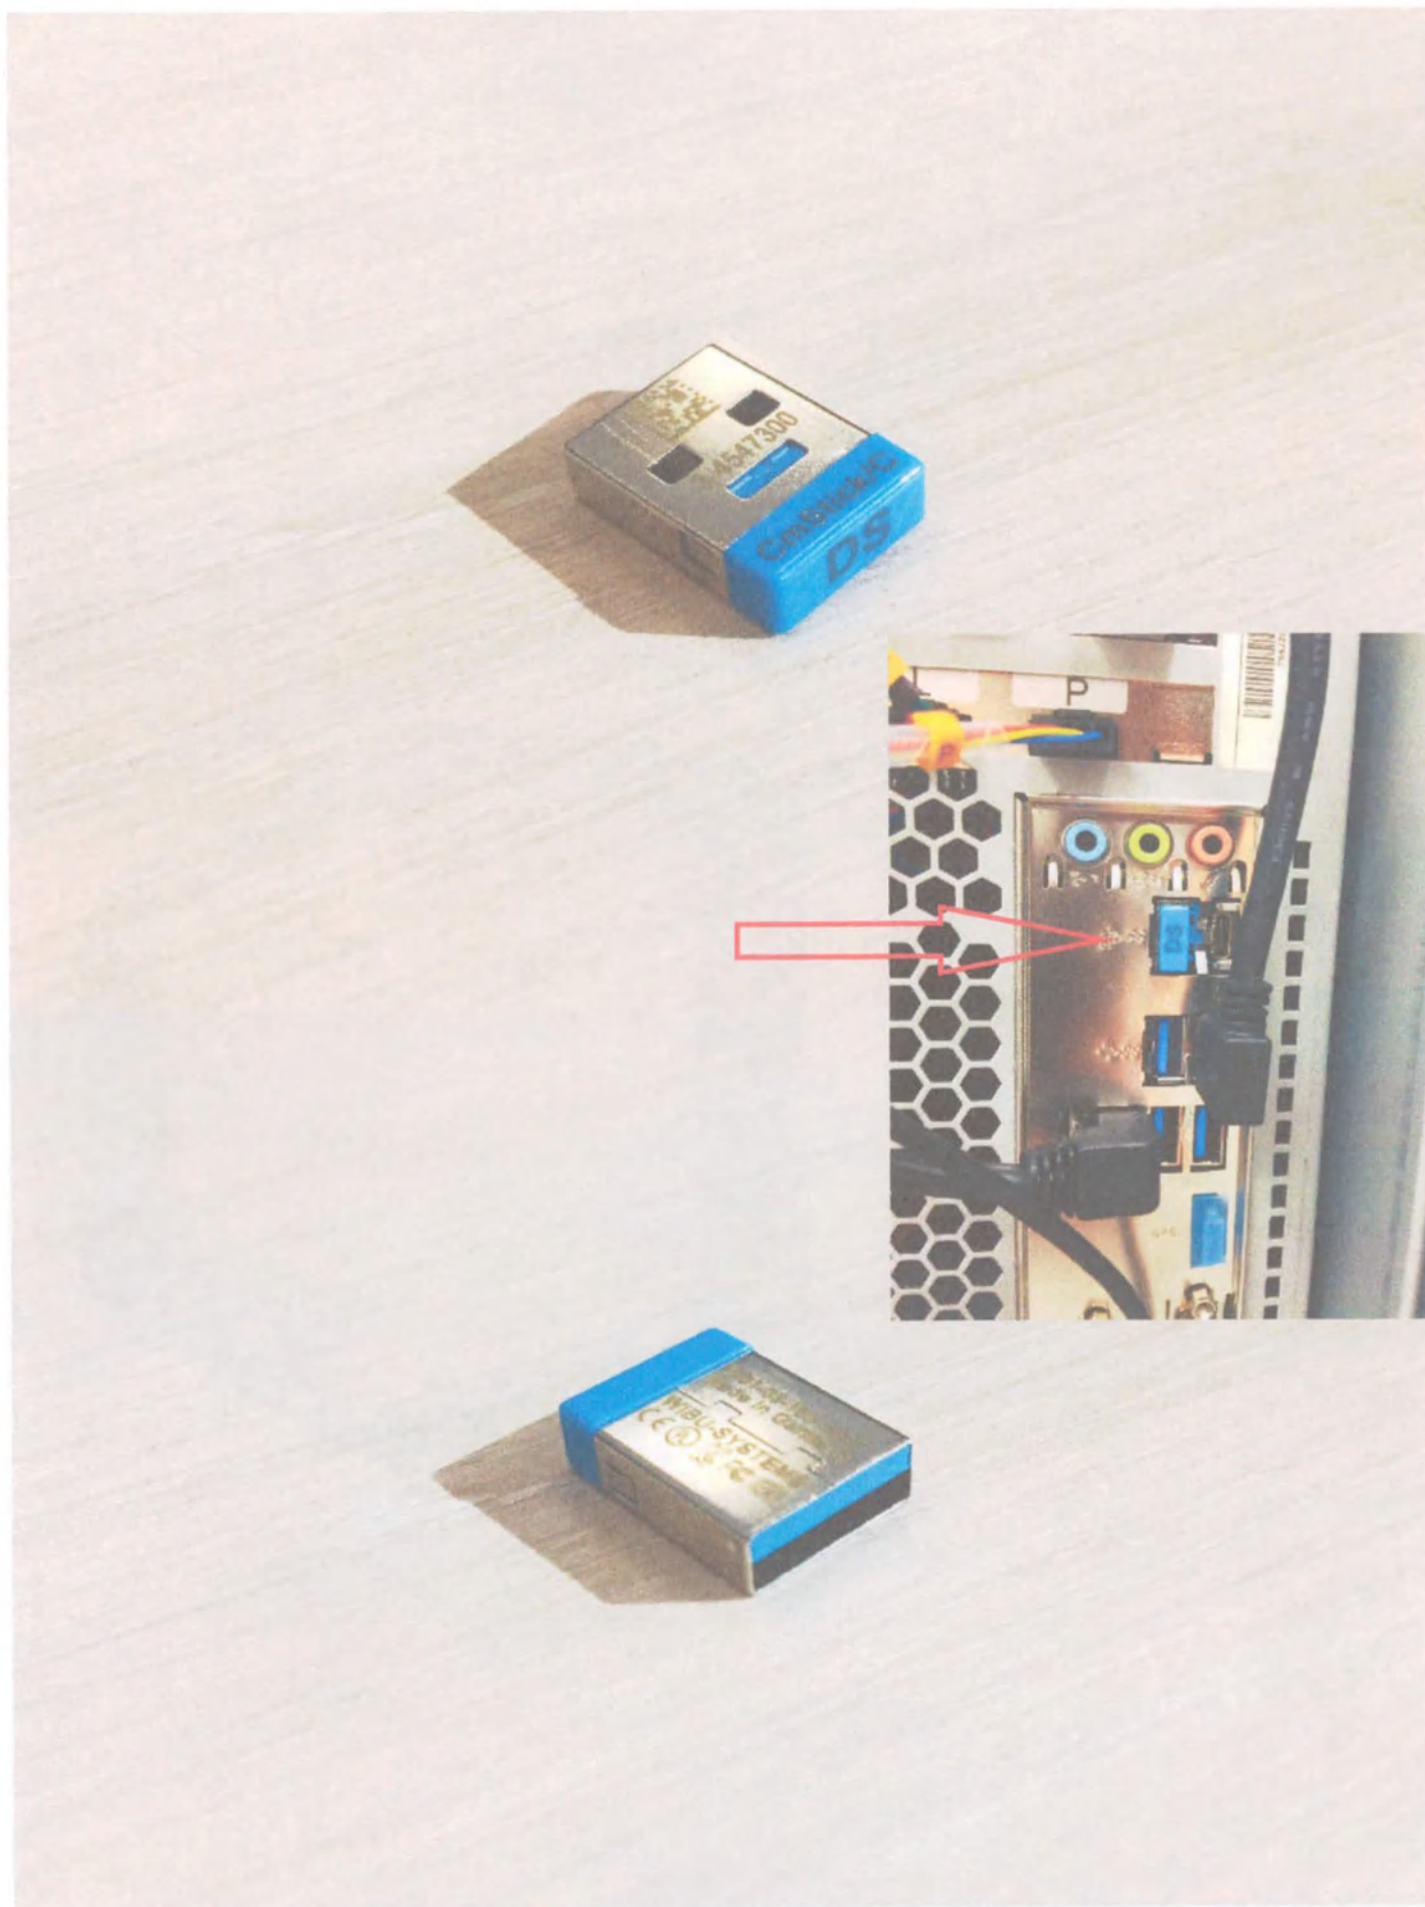

11. Фантом Модель челюсти.



12. Крепеж кабеля питания.

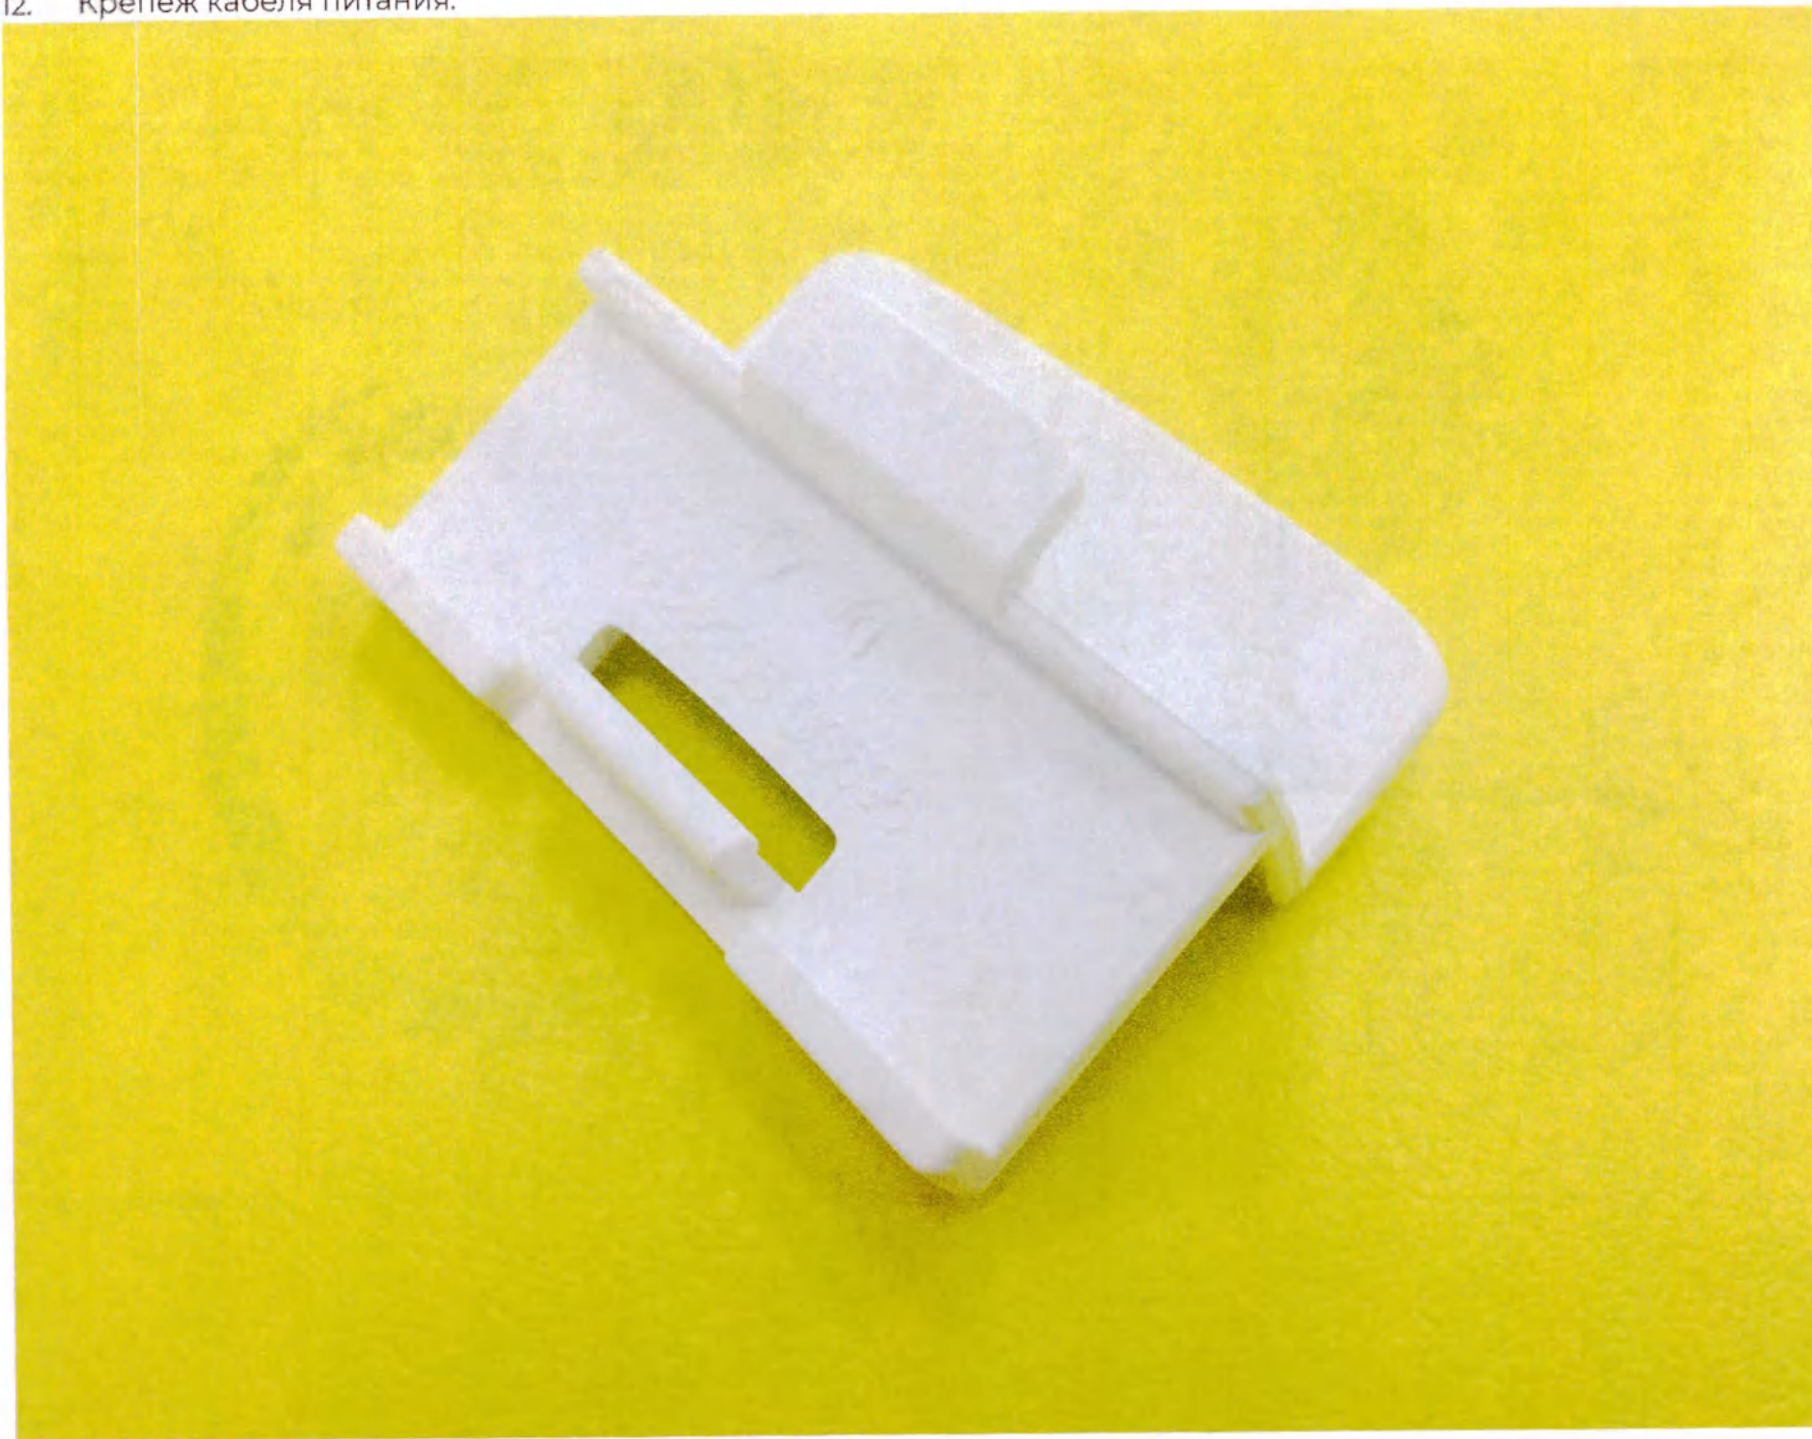

13. Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.




14. Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе



15. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе



16. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера

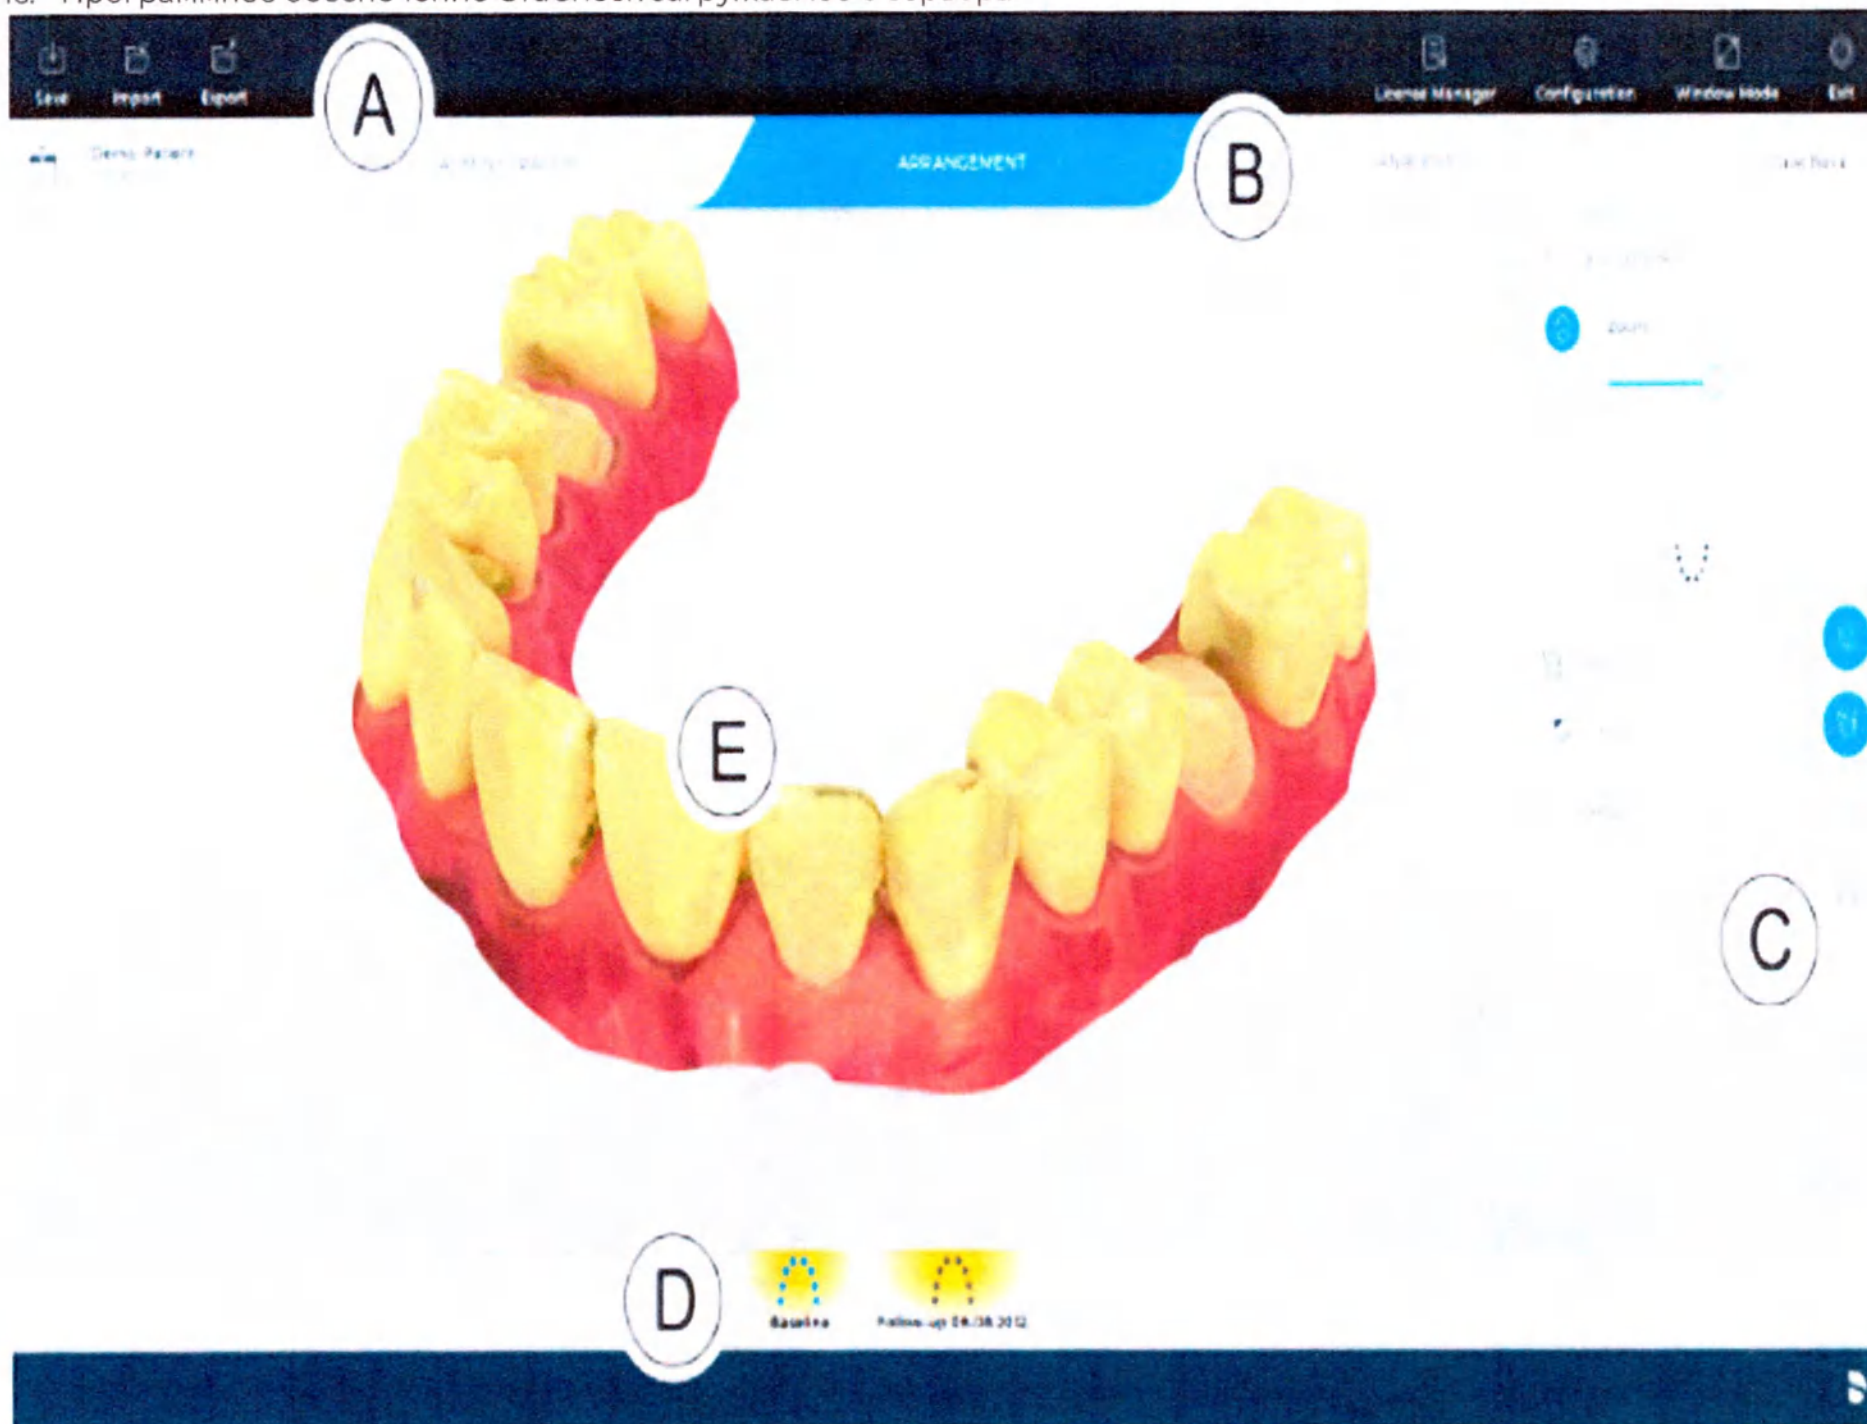



REF. No. 67 08 163



Product M6708163S0000001250
Connect C C InBox (beil.)

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

sirona
The Dental Company



REF. No. 67 39 085



Product M6739085S0000001051
CEREC SW 5.1 & Pro SW Upgrade


License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

THE DENTAL
BOX - 1000000
2000000

**Dentsply
Sirona**



REF. No. 67 27 049



Product M6727049S0000001836
CEREC Ortho SW 2.0 Lizenz

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza


**Dentsply
Sirona**

18. Винт крепежный дл «кумулятора



19. Эксплуатационная документация, в составе:
19.1. инструкция по эксплуатации

Действует с: 01.2019




CEREC Primescan AC, Primescan AC

Инструкция по эксплуатации

Русский




New as of: 09.2018



CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC


Unpacking and Installation Instructions

English

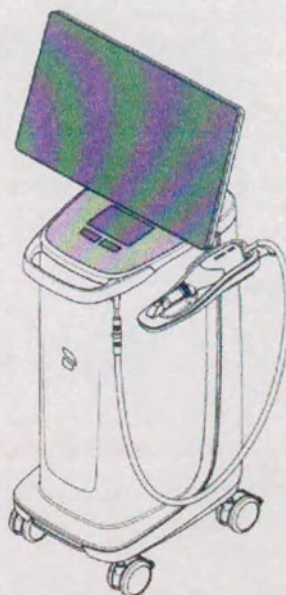



CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

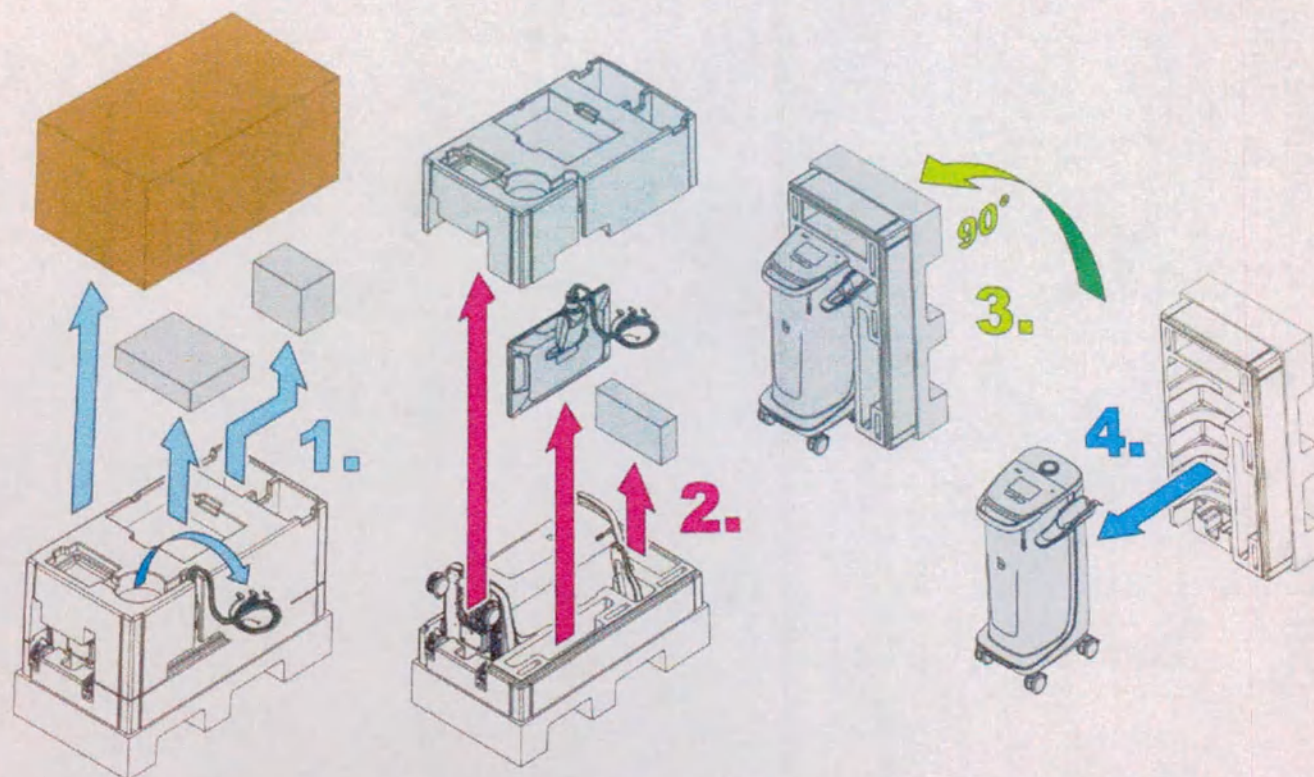

D3696.902.03.01.09 10.2018 A-Nr.: 000 000

67 00 608 D3696

Принадлежности:

1. Аккумулятор.



III. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Omnicam AC.



1. Блок для съемки с т адом или блок для съемки с шаровт манипулятором.



2. Монитор.



3. Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam).



4. Кабель питания.






5. Насадка калибровочная для настройки точности.




6. Насадка калибровочная для настройки цвета.



7. Наконечник одноразовый для камеры **Omnica**

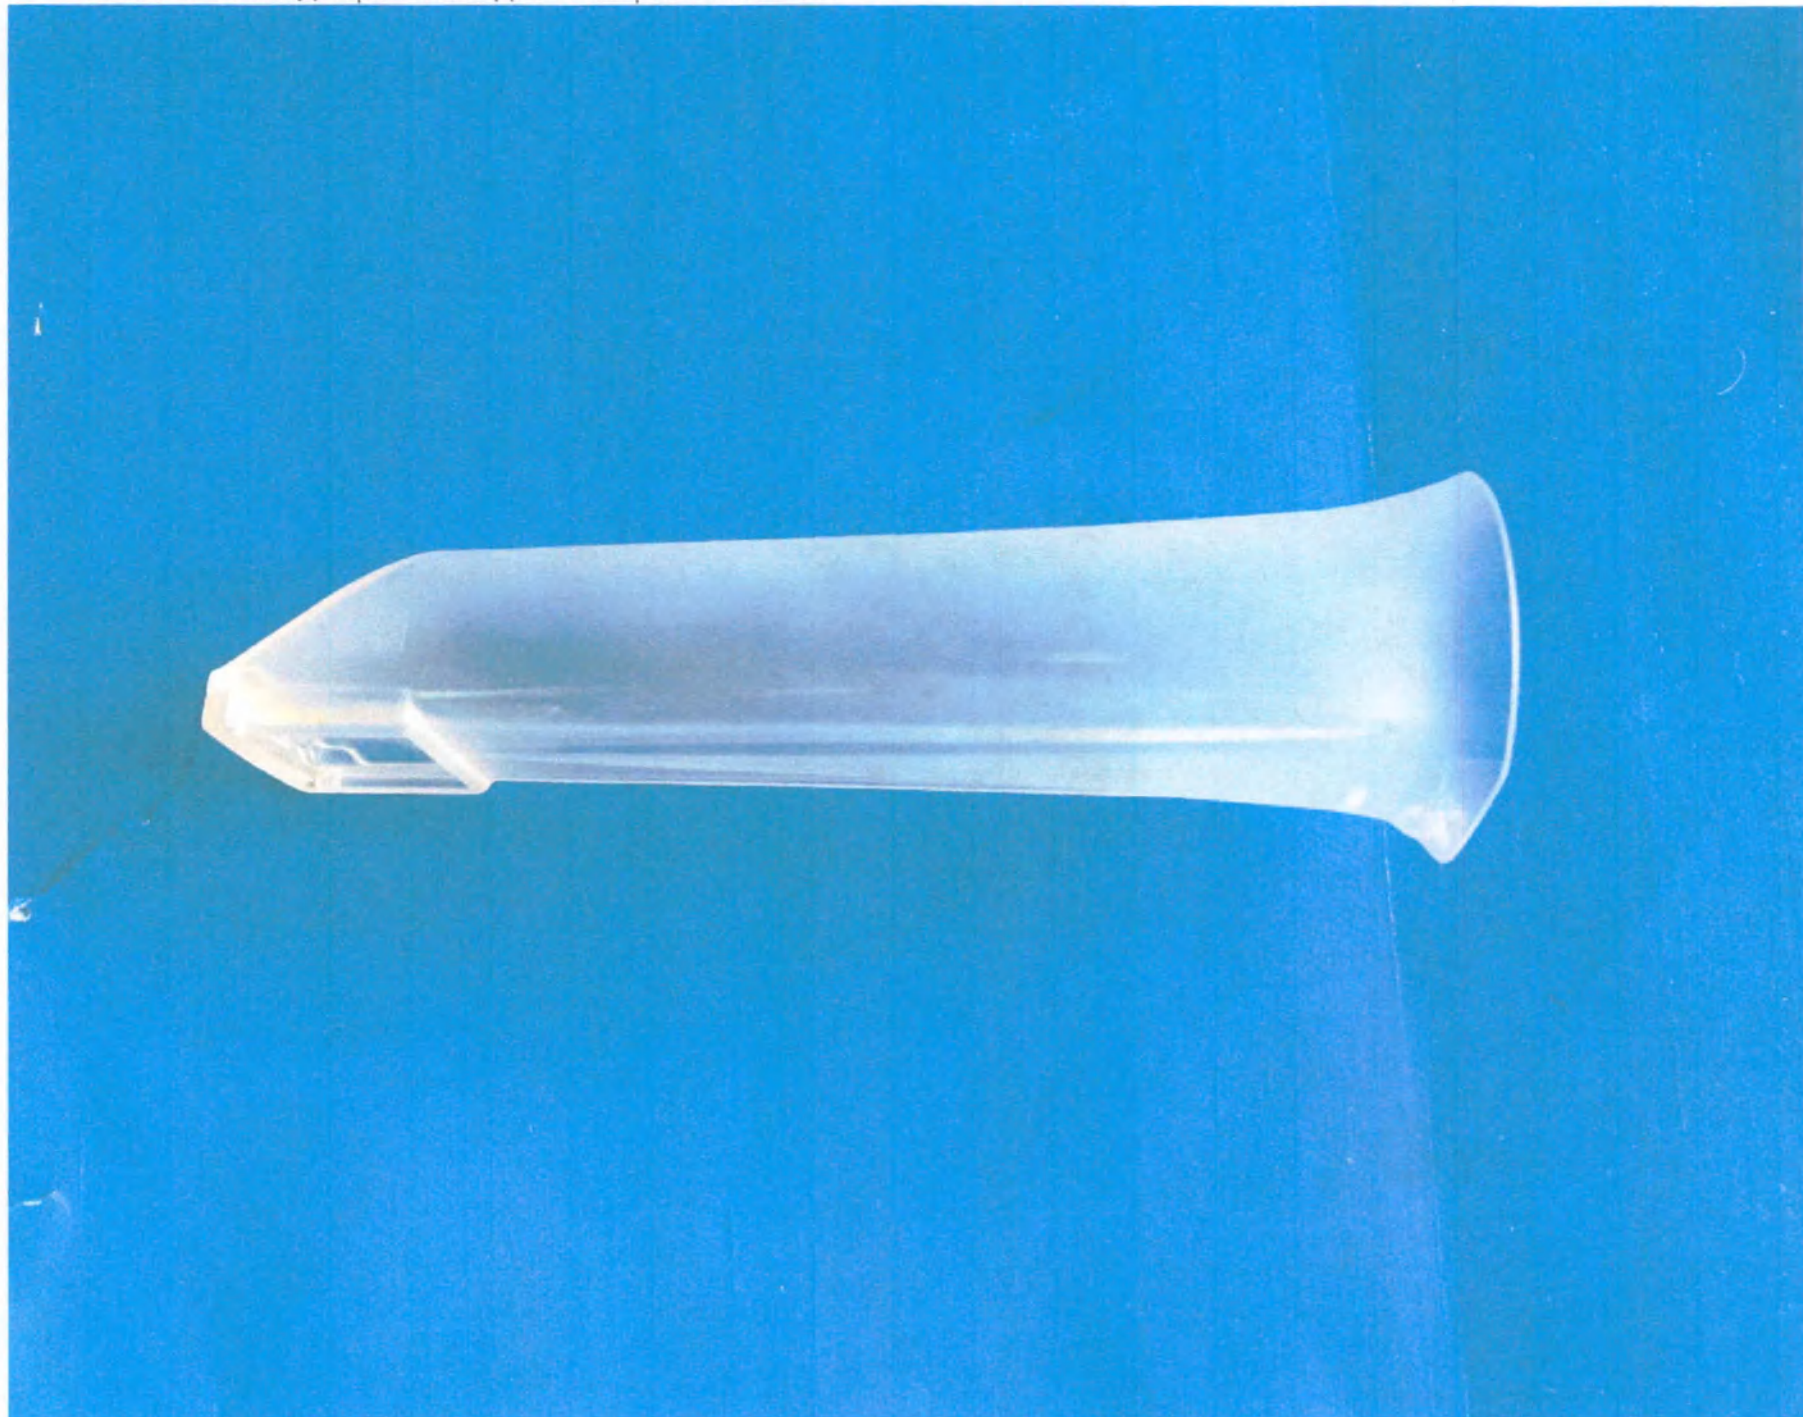

8. USB носитель с прогнанными лицензиями.

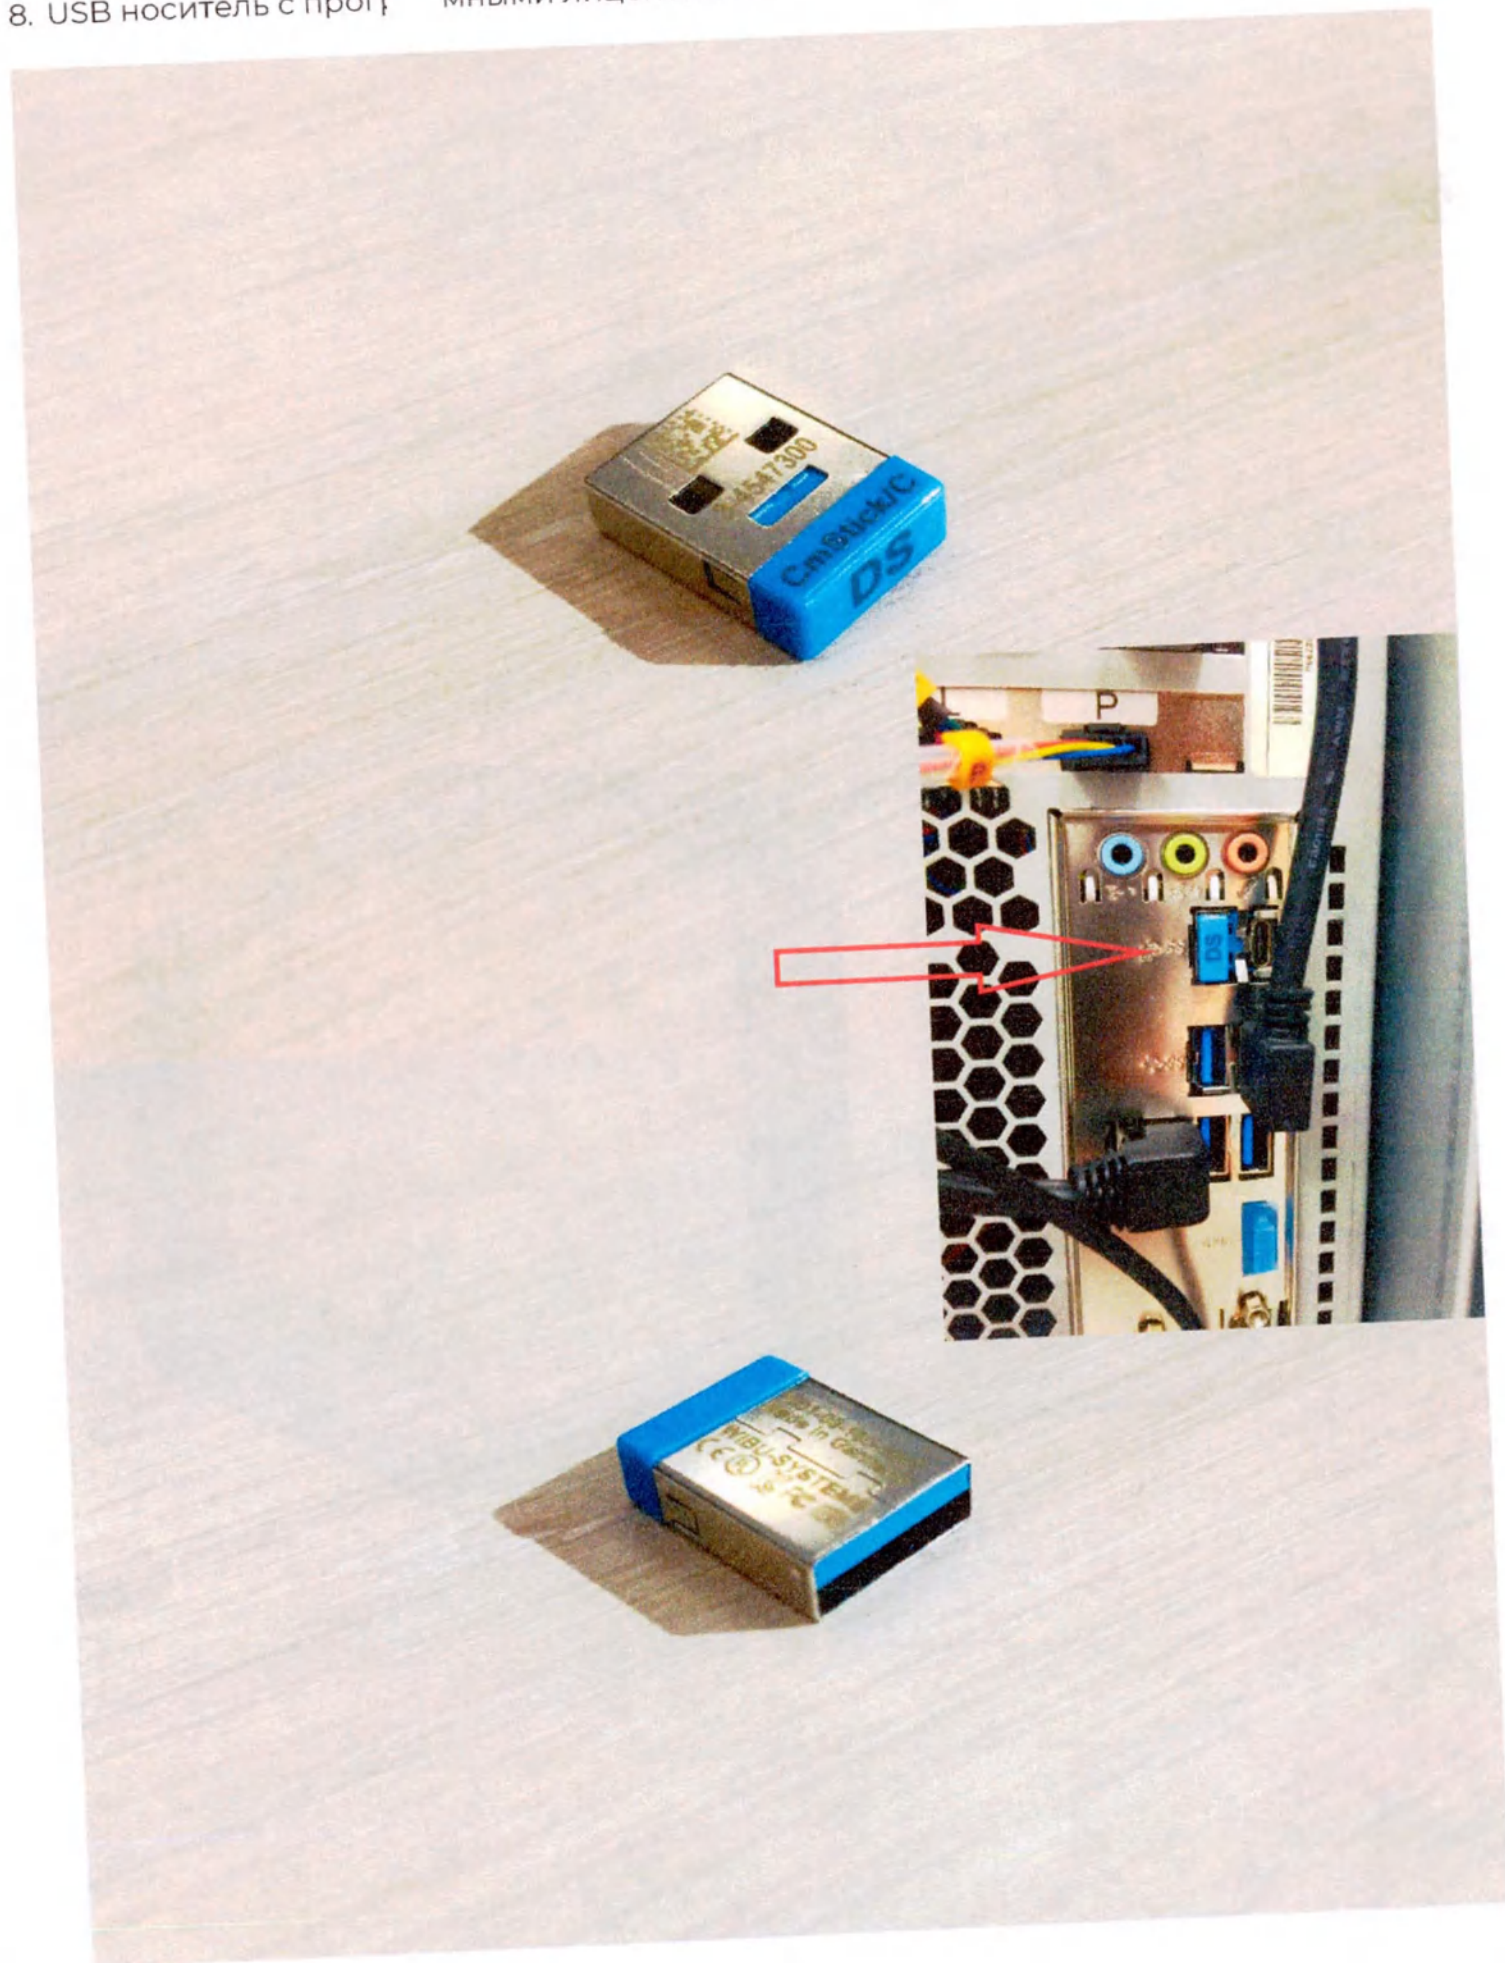

9. Фантом Модель челюсти.



10. Крепеж кабеля питания.




11. Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.



12. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе.



13. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера.

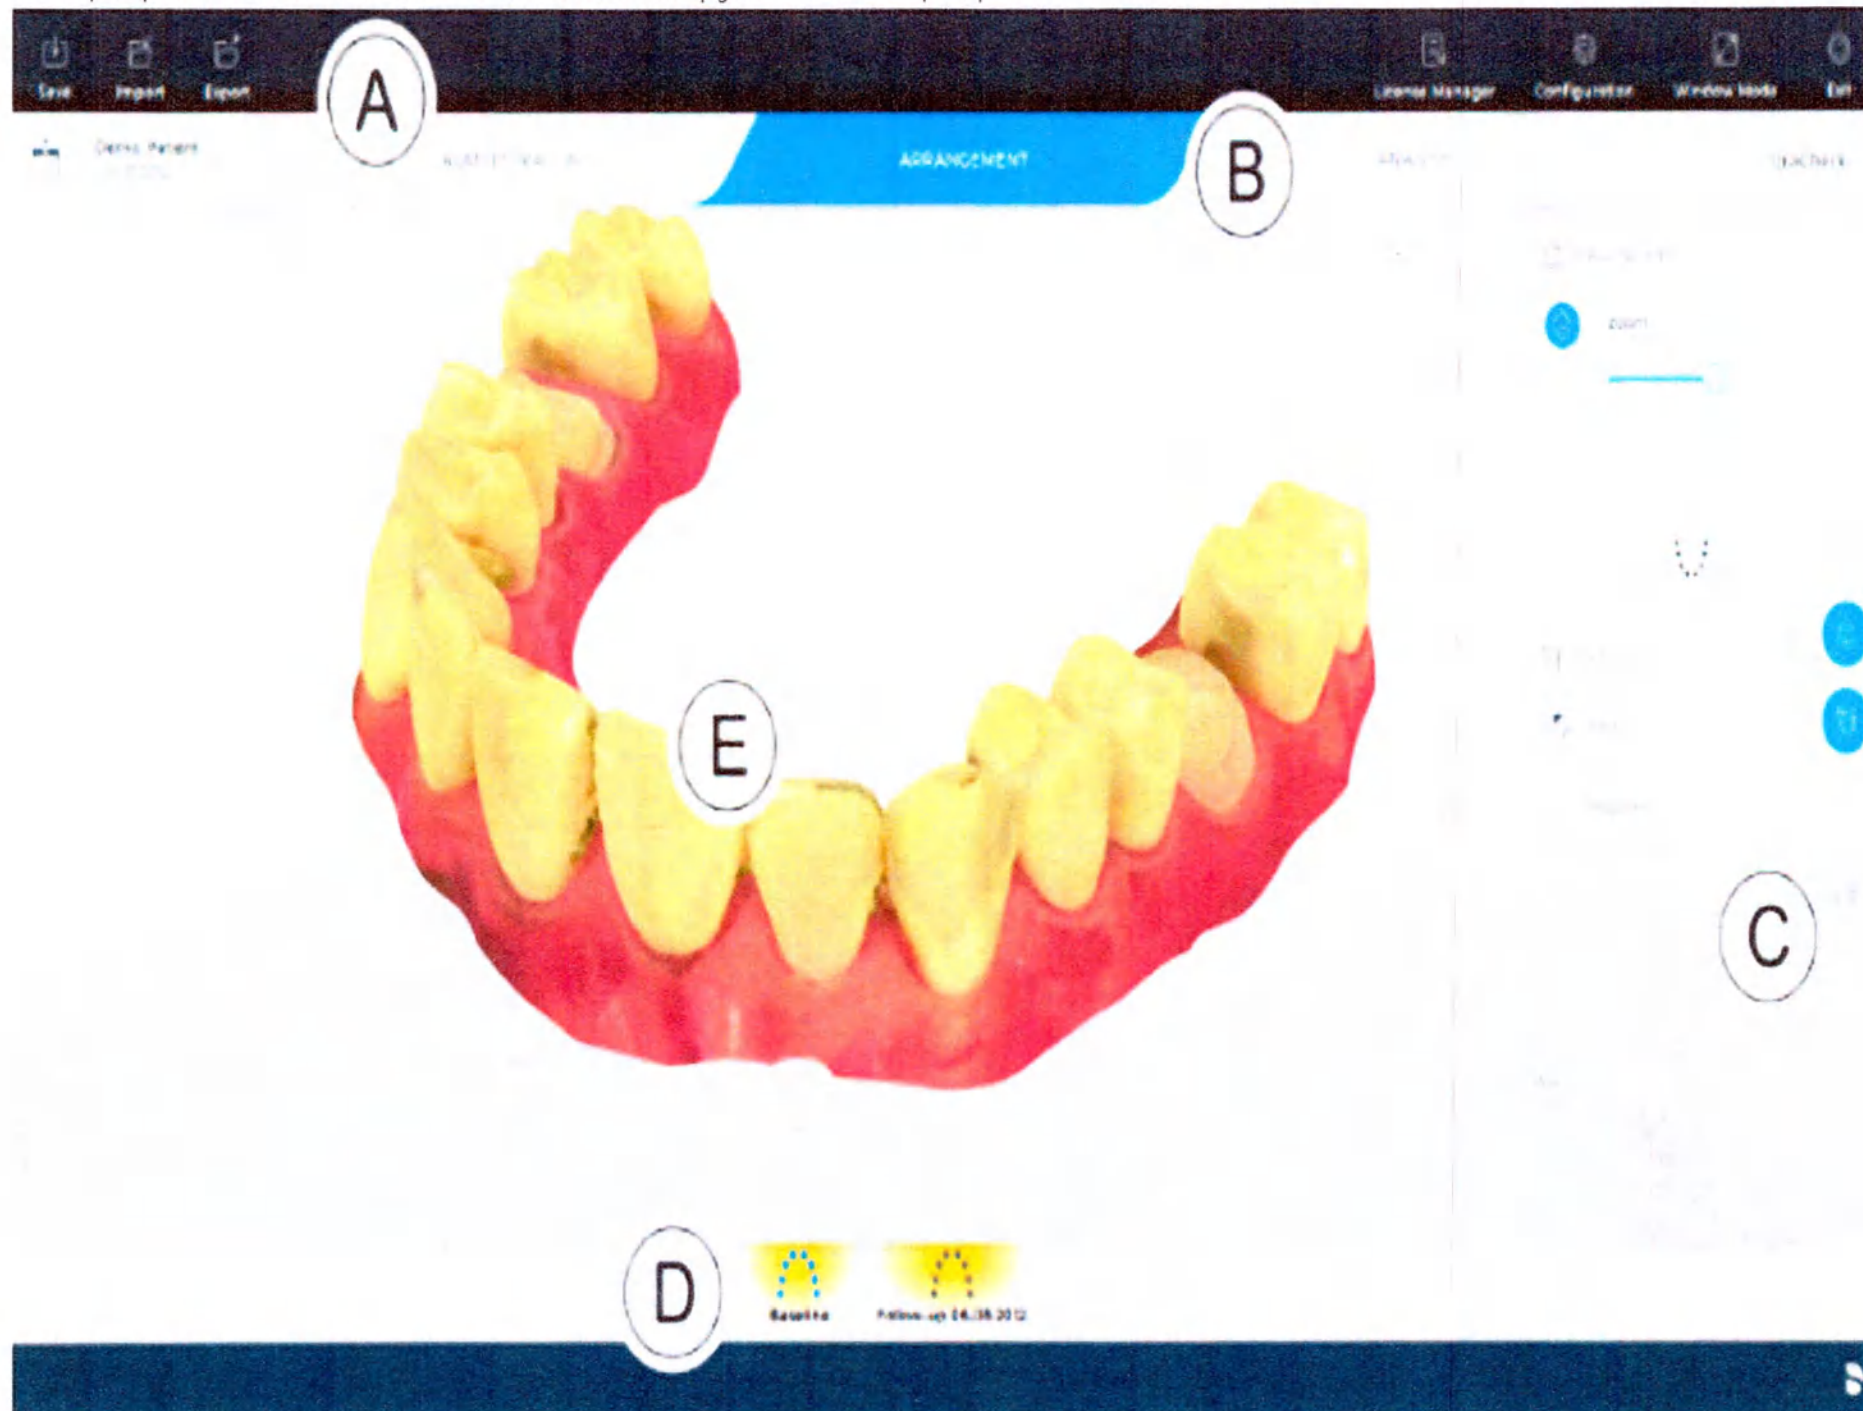

14. Лицензионные коды Cense Voucher.



15. Винт крепежный дл ккумулятора



16. Эксплуатационная документация, в составе:

16.1. инструкция по эксплуатации


Действует с: 01.2019

Dentsply
Sirona


CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

Инструкция по эксплуатации

Русский

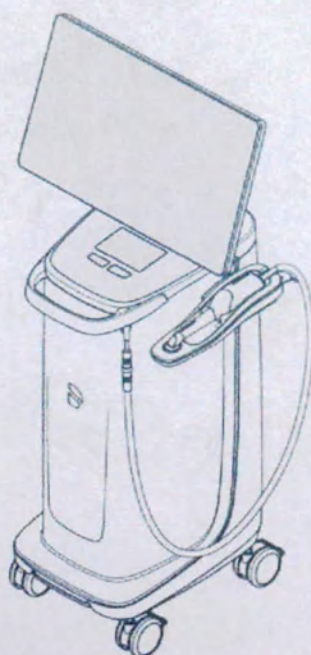


New as of: 09.2018




CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC


Unpacking and Installation Instructions

English

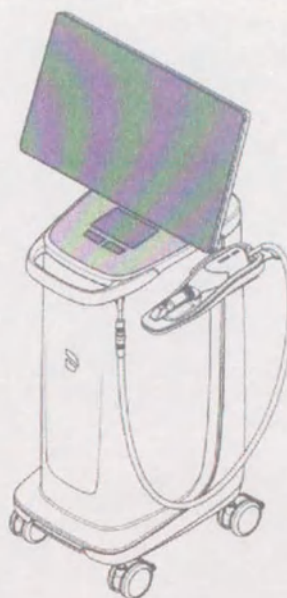



CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

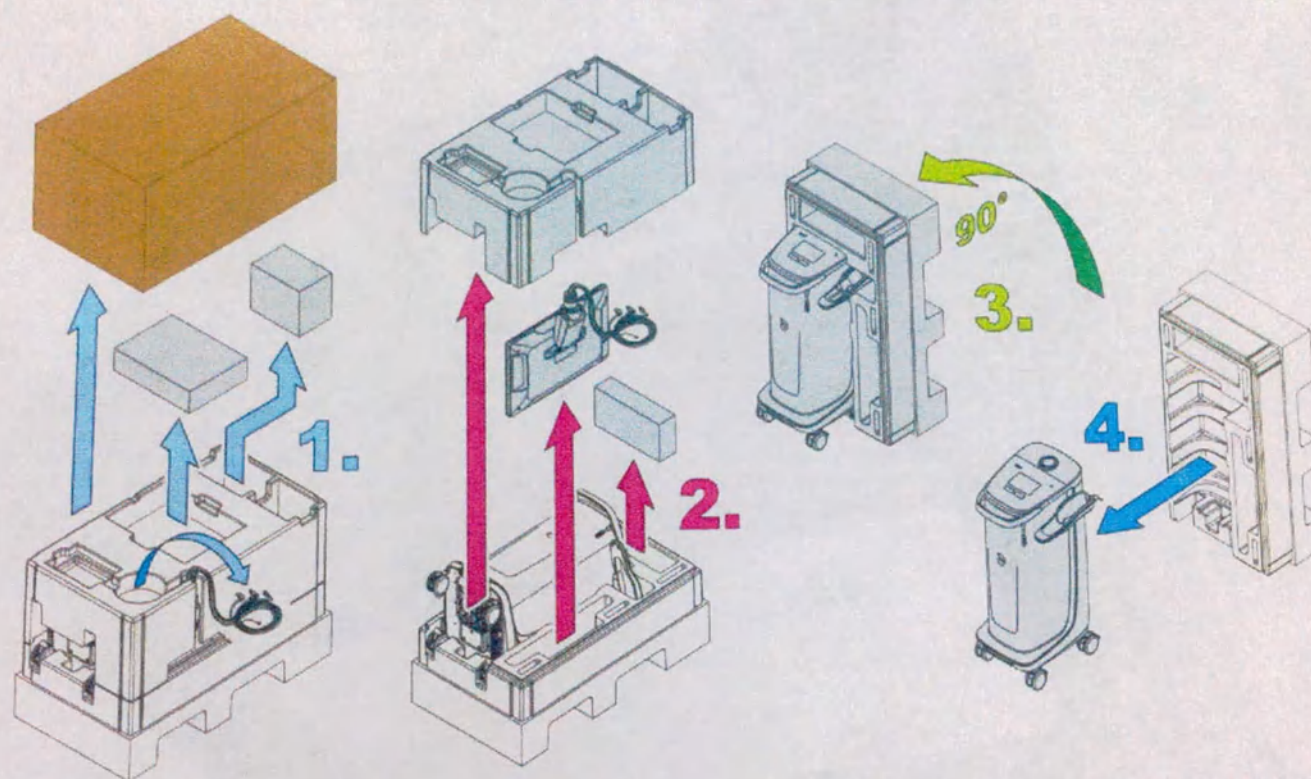

D3696.902.03.01.09 10.2018 A-Nr.: 000 000

67 00 608 D3696

Принадлежности:

1. Аккумулятор.




IV. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Omnicam AC.



1. Блок для съемки (с чпадом или блок для съемки с шарс м манипулятором.



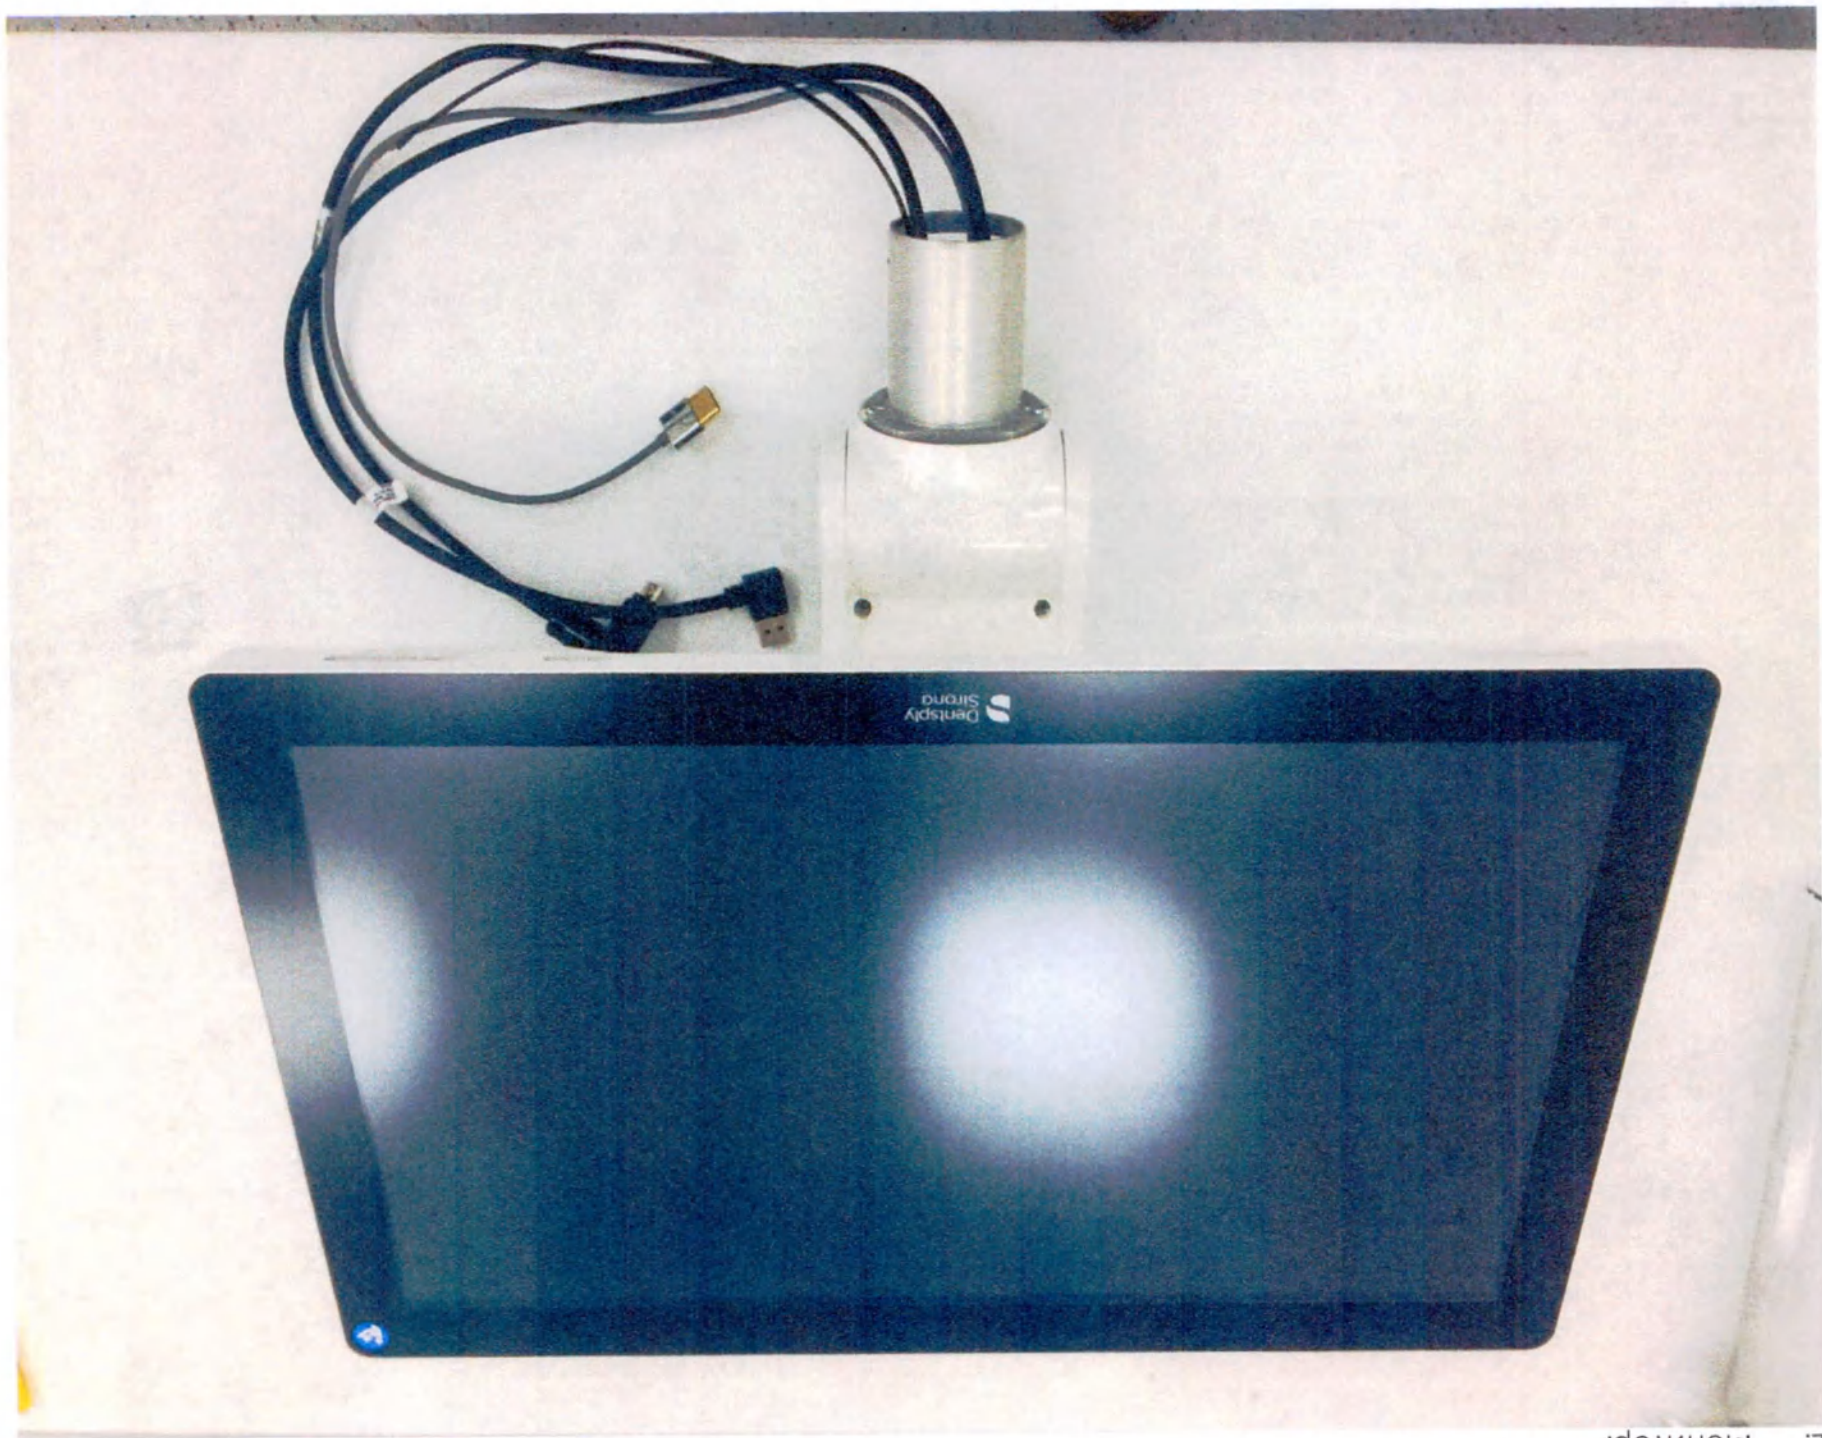


2. Монитор.

3. Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam).



4. Кабель питания.

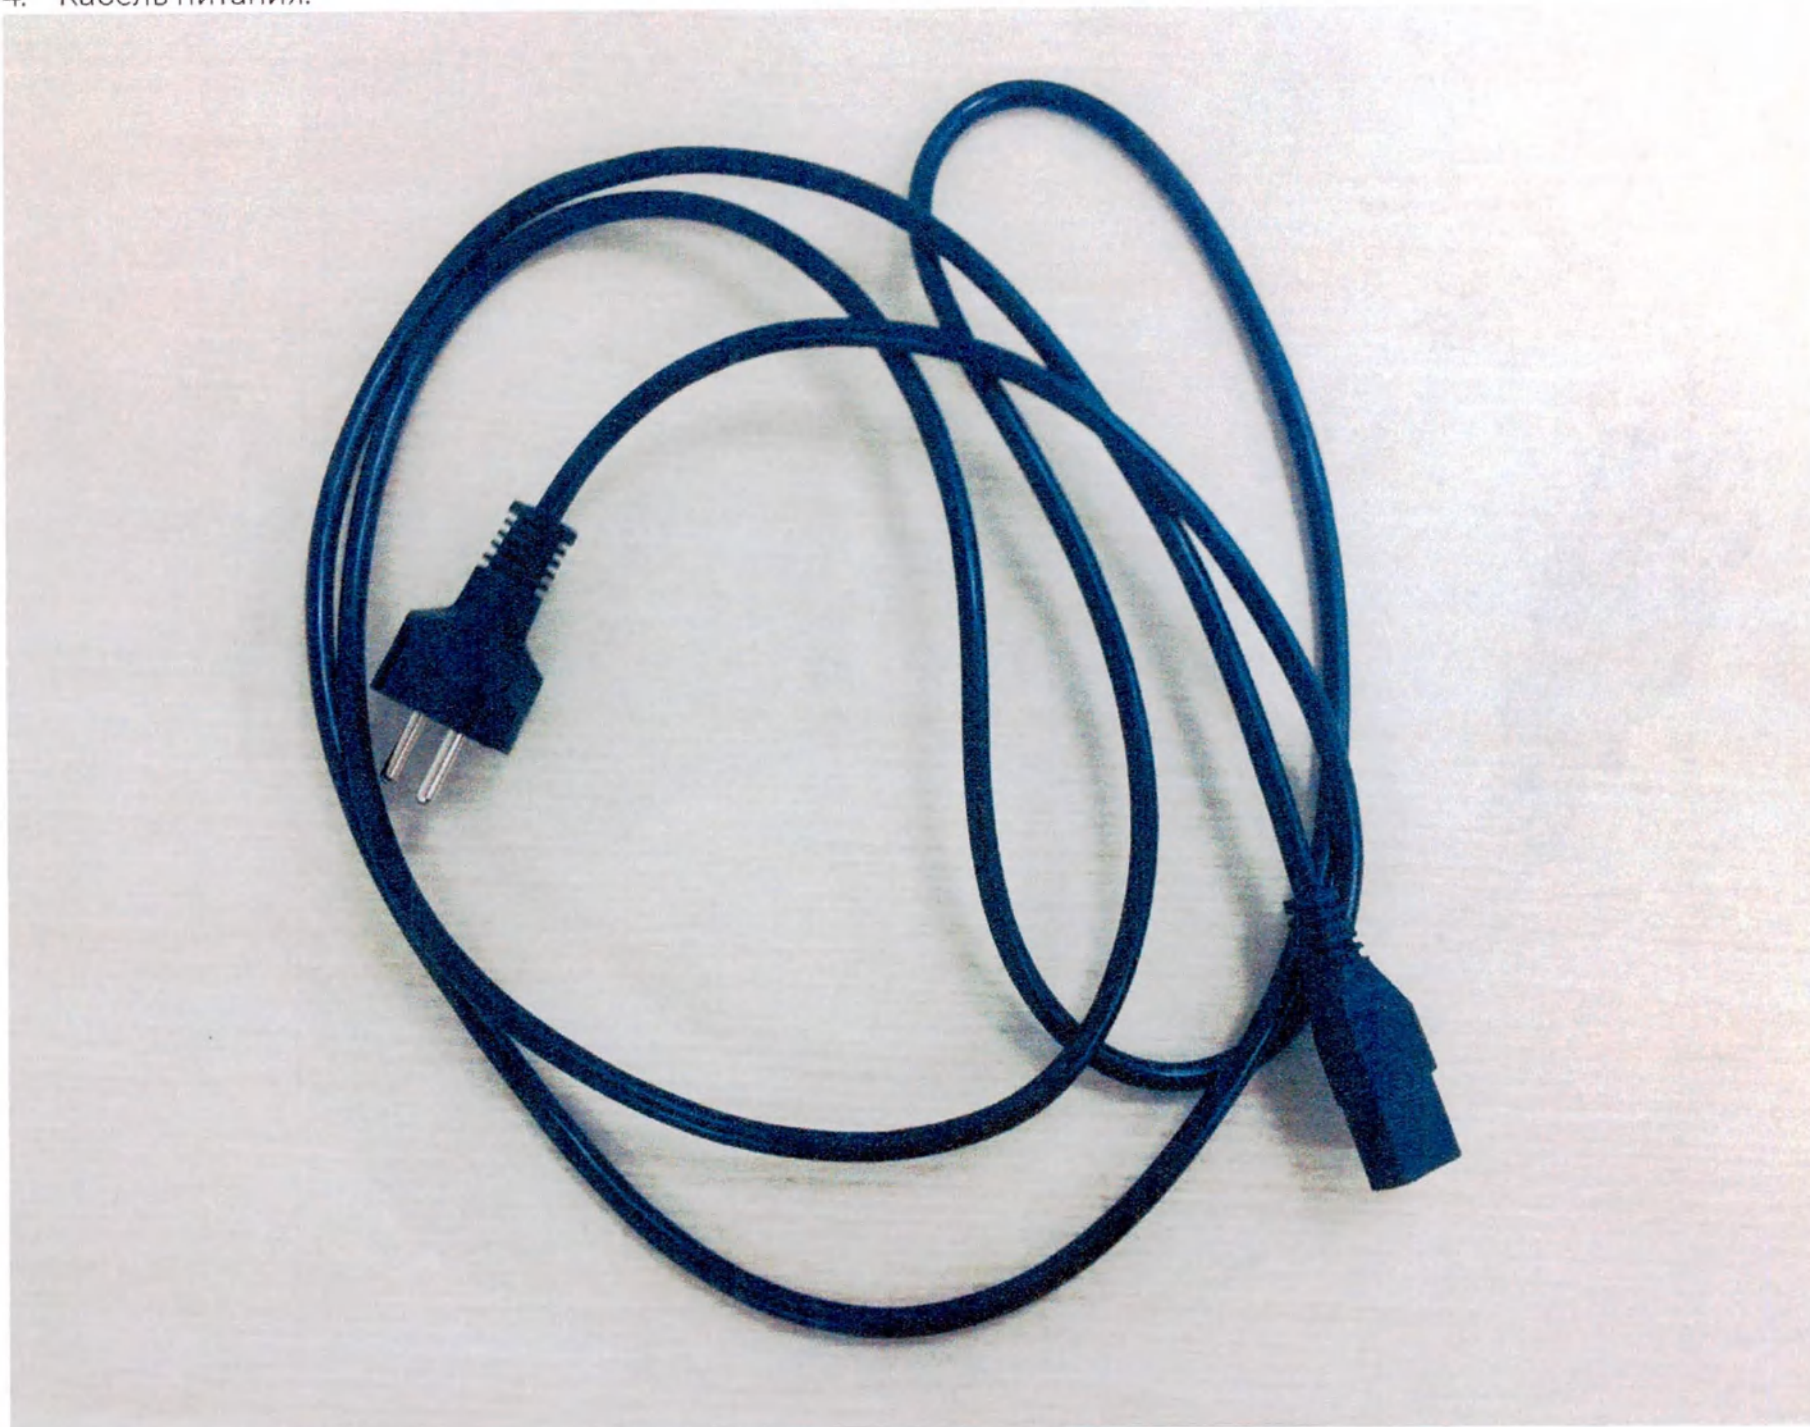




5. Насадка калибровочная для настройки точности.




6. Насадка калибровочная для настройки цвета.



7. Наконечник одноразовый для камеры Omnicam.

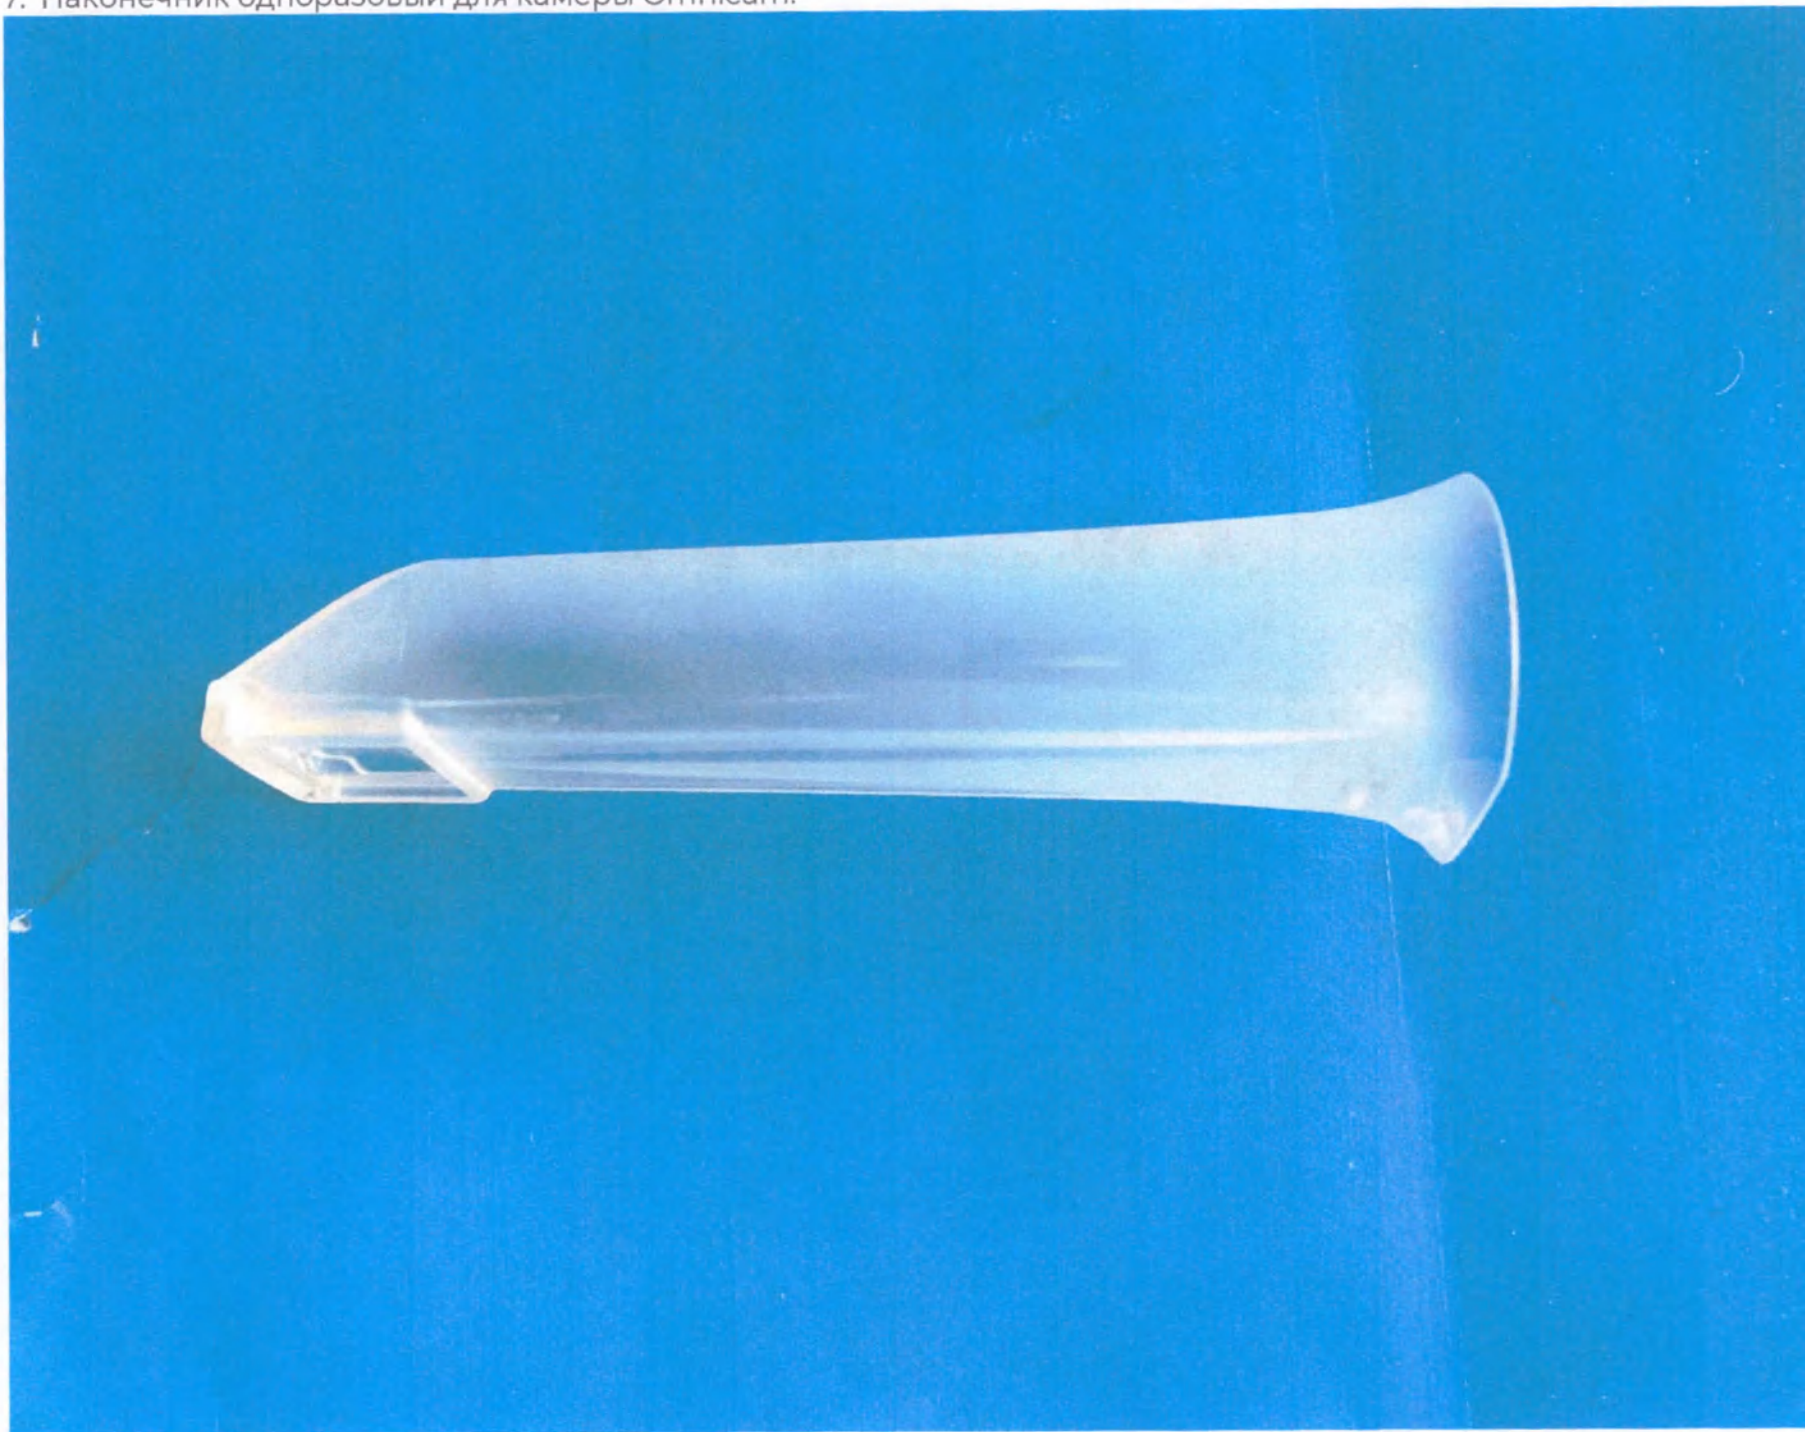

8. USB носитель с программными лицензиями.

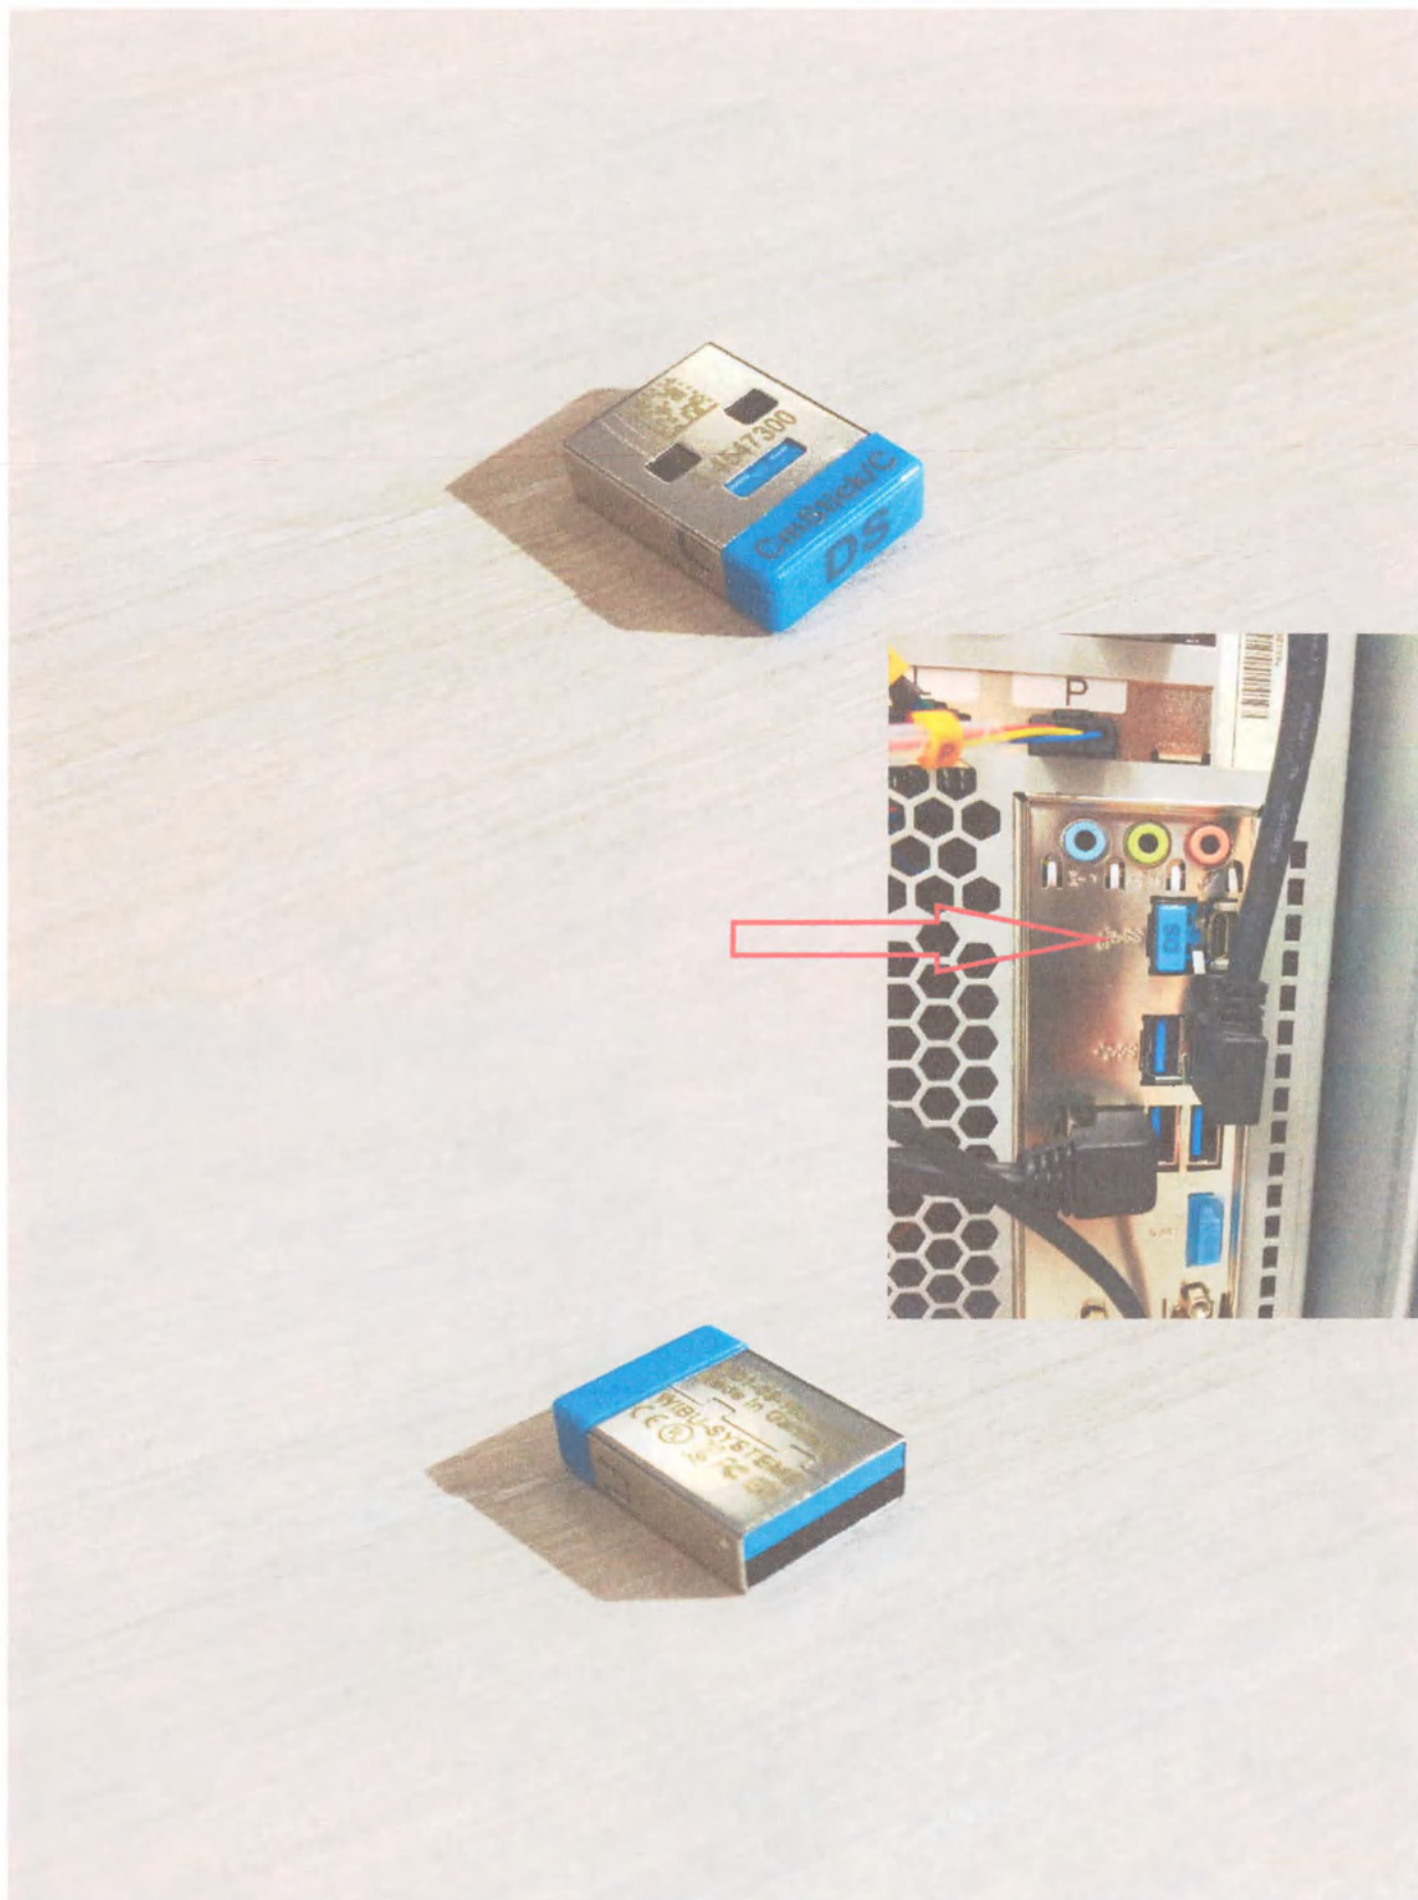

9. Фантом Модель челюсти.



10. Крепеж кабеля питания.



11. Программное обеспечение Connect SW на электронном носителе.




12. Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе



13. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе



14. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера

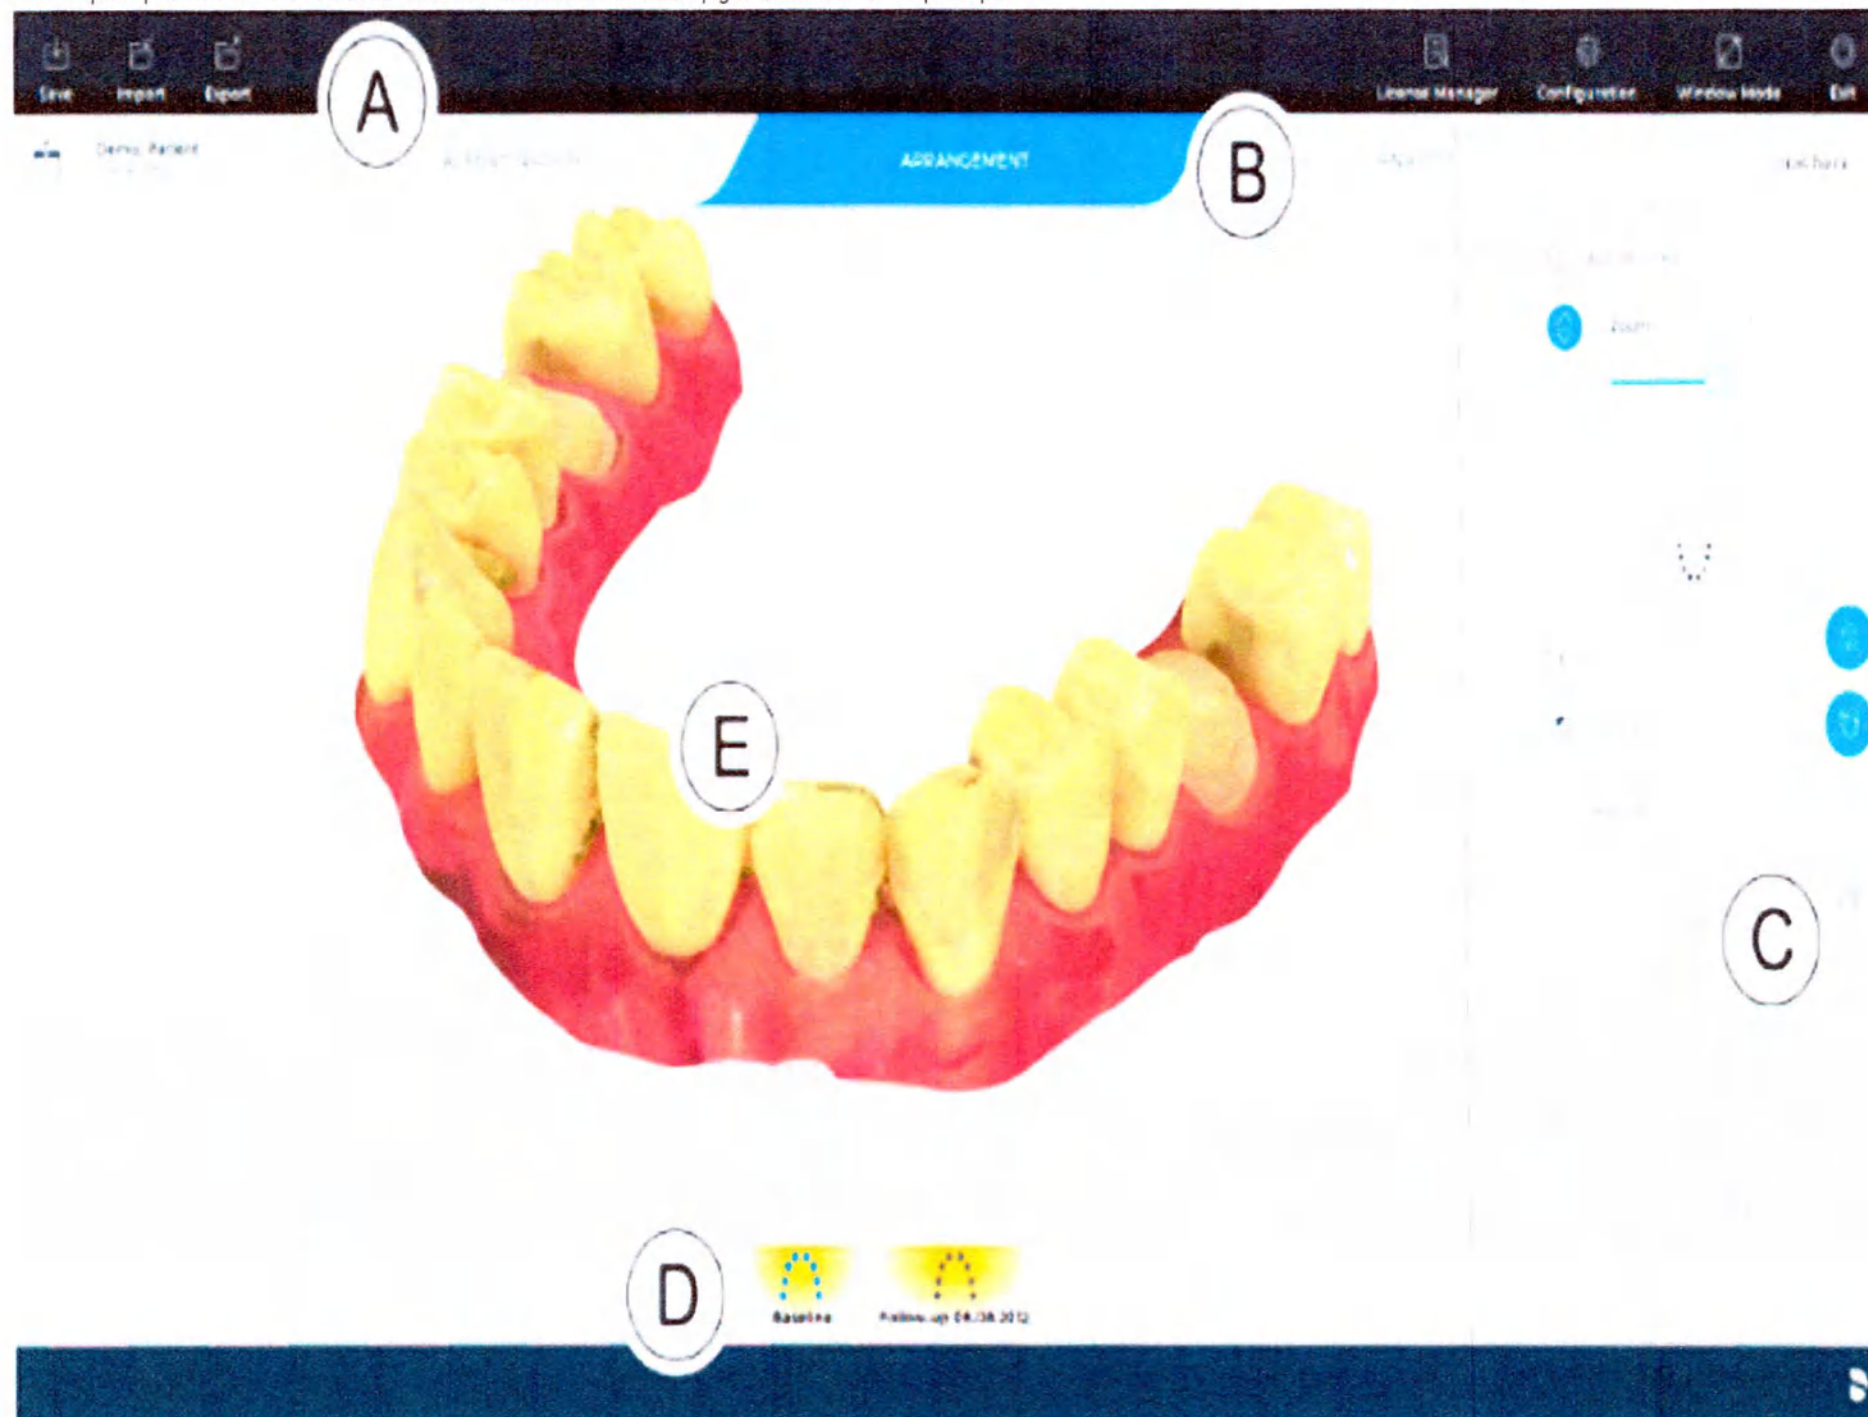



REF. No. 67 08 163



Product M670816350000001250
Connect C C InBox (beil.)

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

sirona
The Dental Company



REF. No 67 39 085



Product M673908550000001051
CEREC SW 5.1 & Pro SW-Upgrade


License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

THE DENTAL
SOLUTION

**Dentsply
Sirona**



REF. No. 67 27 049



Product M672704950000001836
CEREC Ortho SW 2.0 Lizenz

License Voucher
Lizenzgutschein
Bon pour licence
Vale licencia
Buono licenza

**Dentsply
Sirona**


16. Винт крепежный для аккумулятора



17. Эксплуатационная документация, в составе:

17.1. инструкция по эксплуатации


Действует с: 01.2019



CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

Инструкция по эксплуатации

Русский

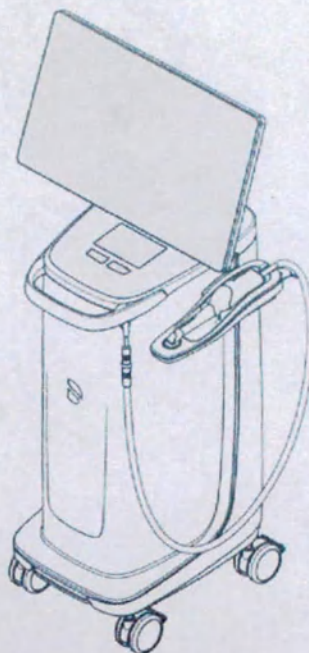


New as of: 09.2018


 Dentsply
Sirona

CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC


Unpacking and Installation Instructions

English

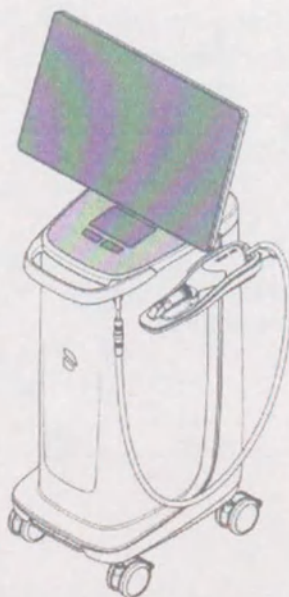



CEREC Primescan AC, Primescan AC,
CEREC Omnicam AC, Omnicam AC

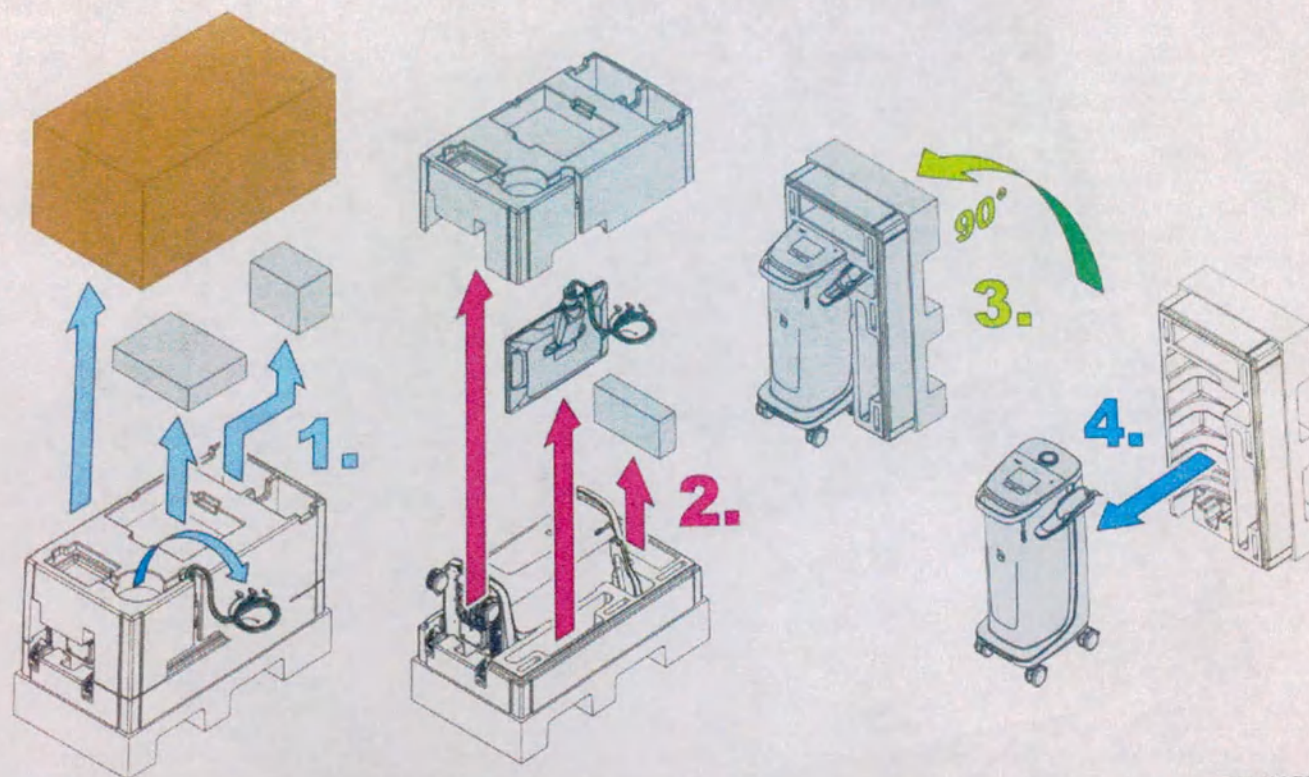

D3696.902.03.01.09 10.2018 A-Nr.: 000 000


67 00 608 D3696

Принадлежности:

1. Аккумулятор.



V. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Omnicam:

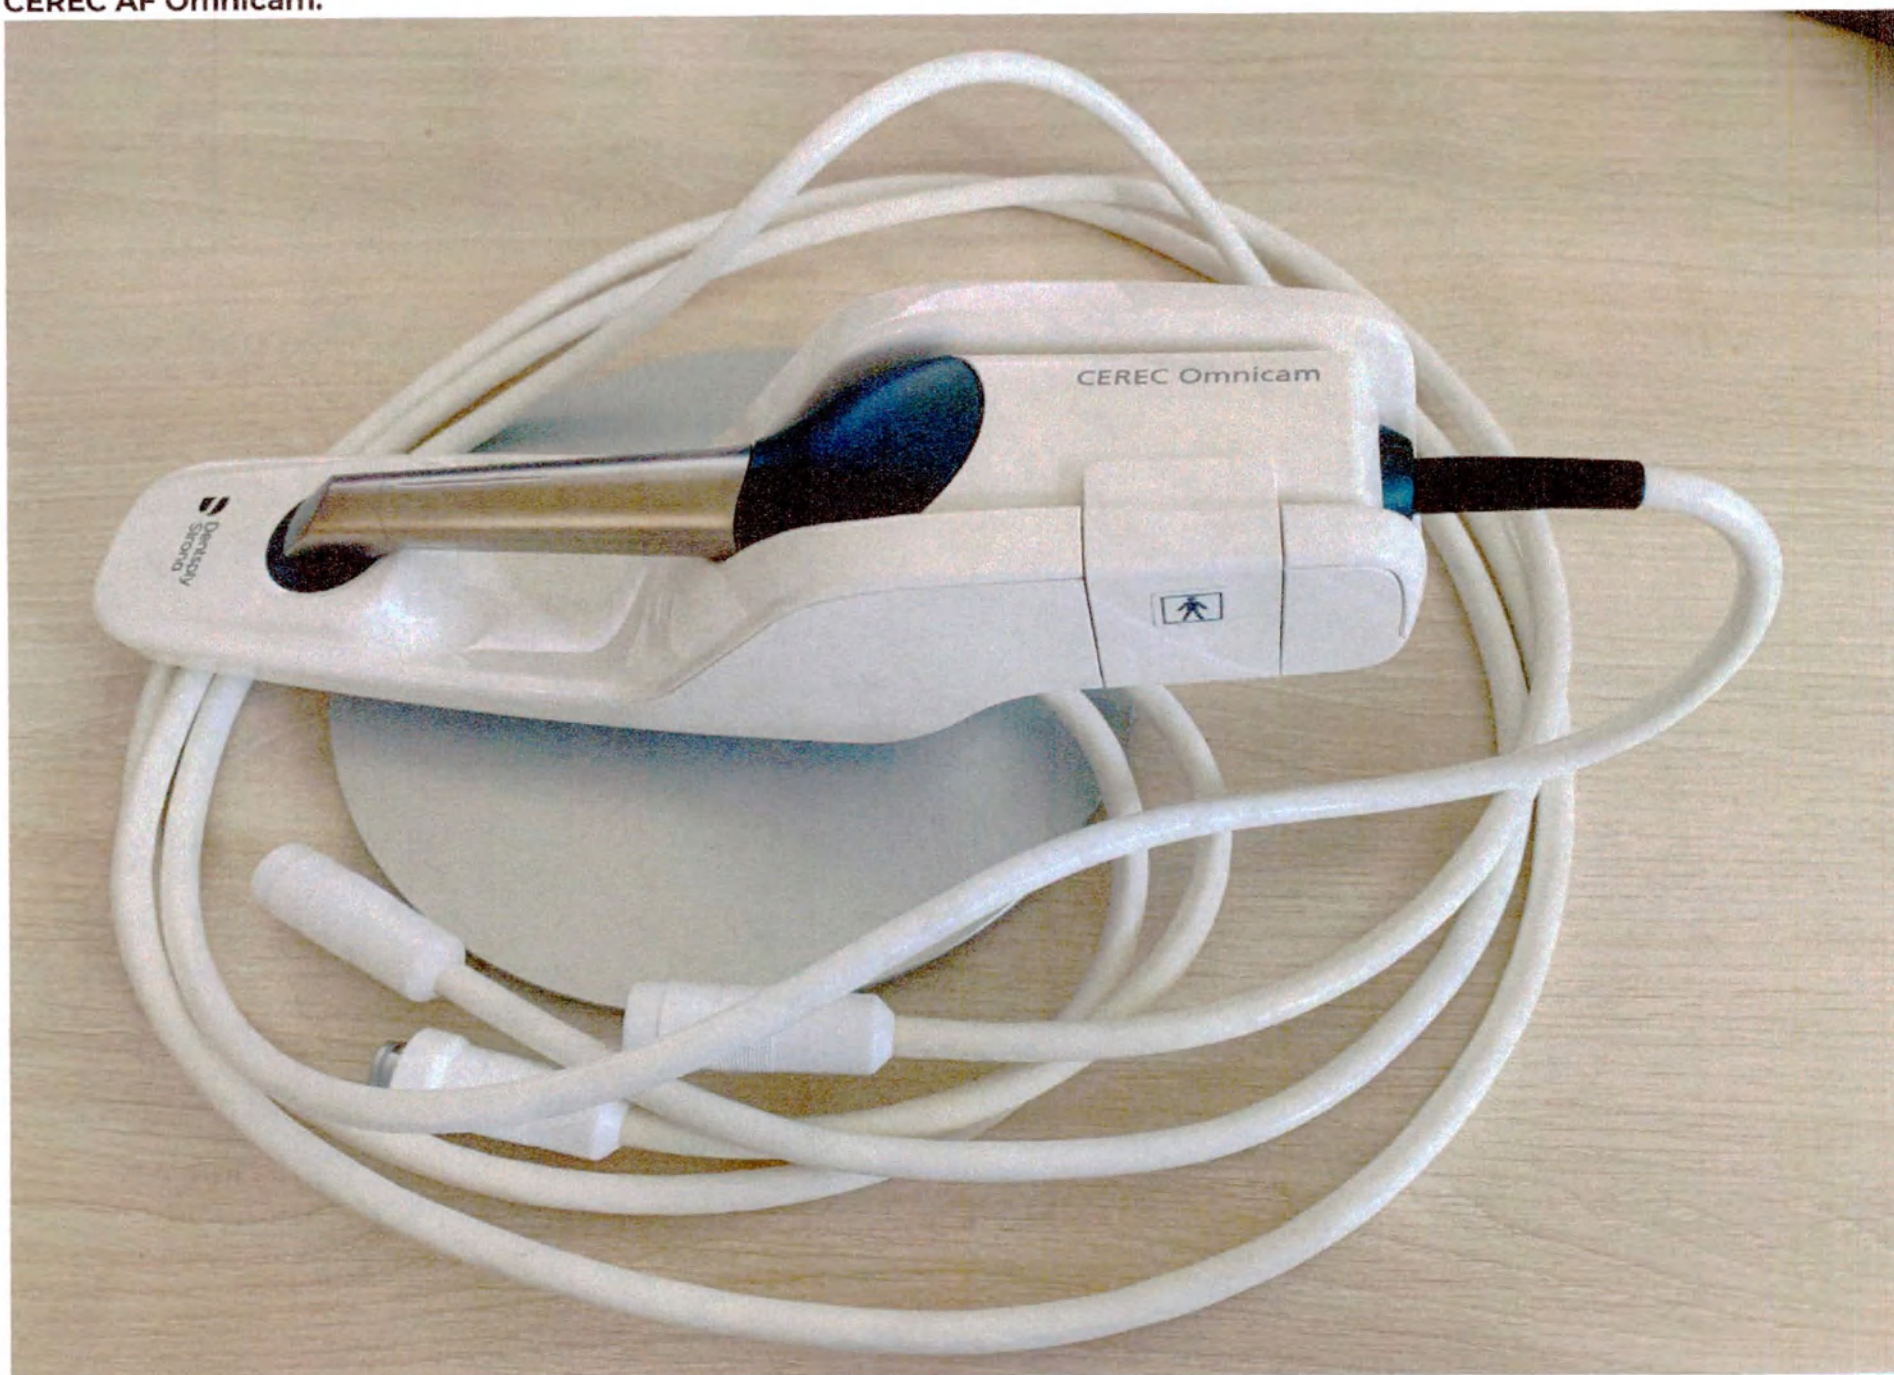

1. Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam)



2. Держатель камеры




3. Насадка калибровочная для настройки точности




4. Насадка калибровочная для настройки цвета



5. Защитные крышки

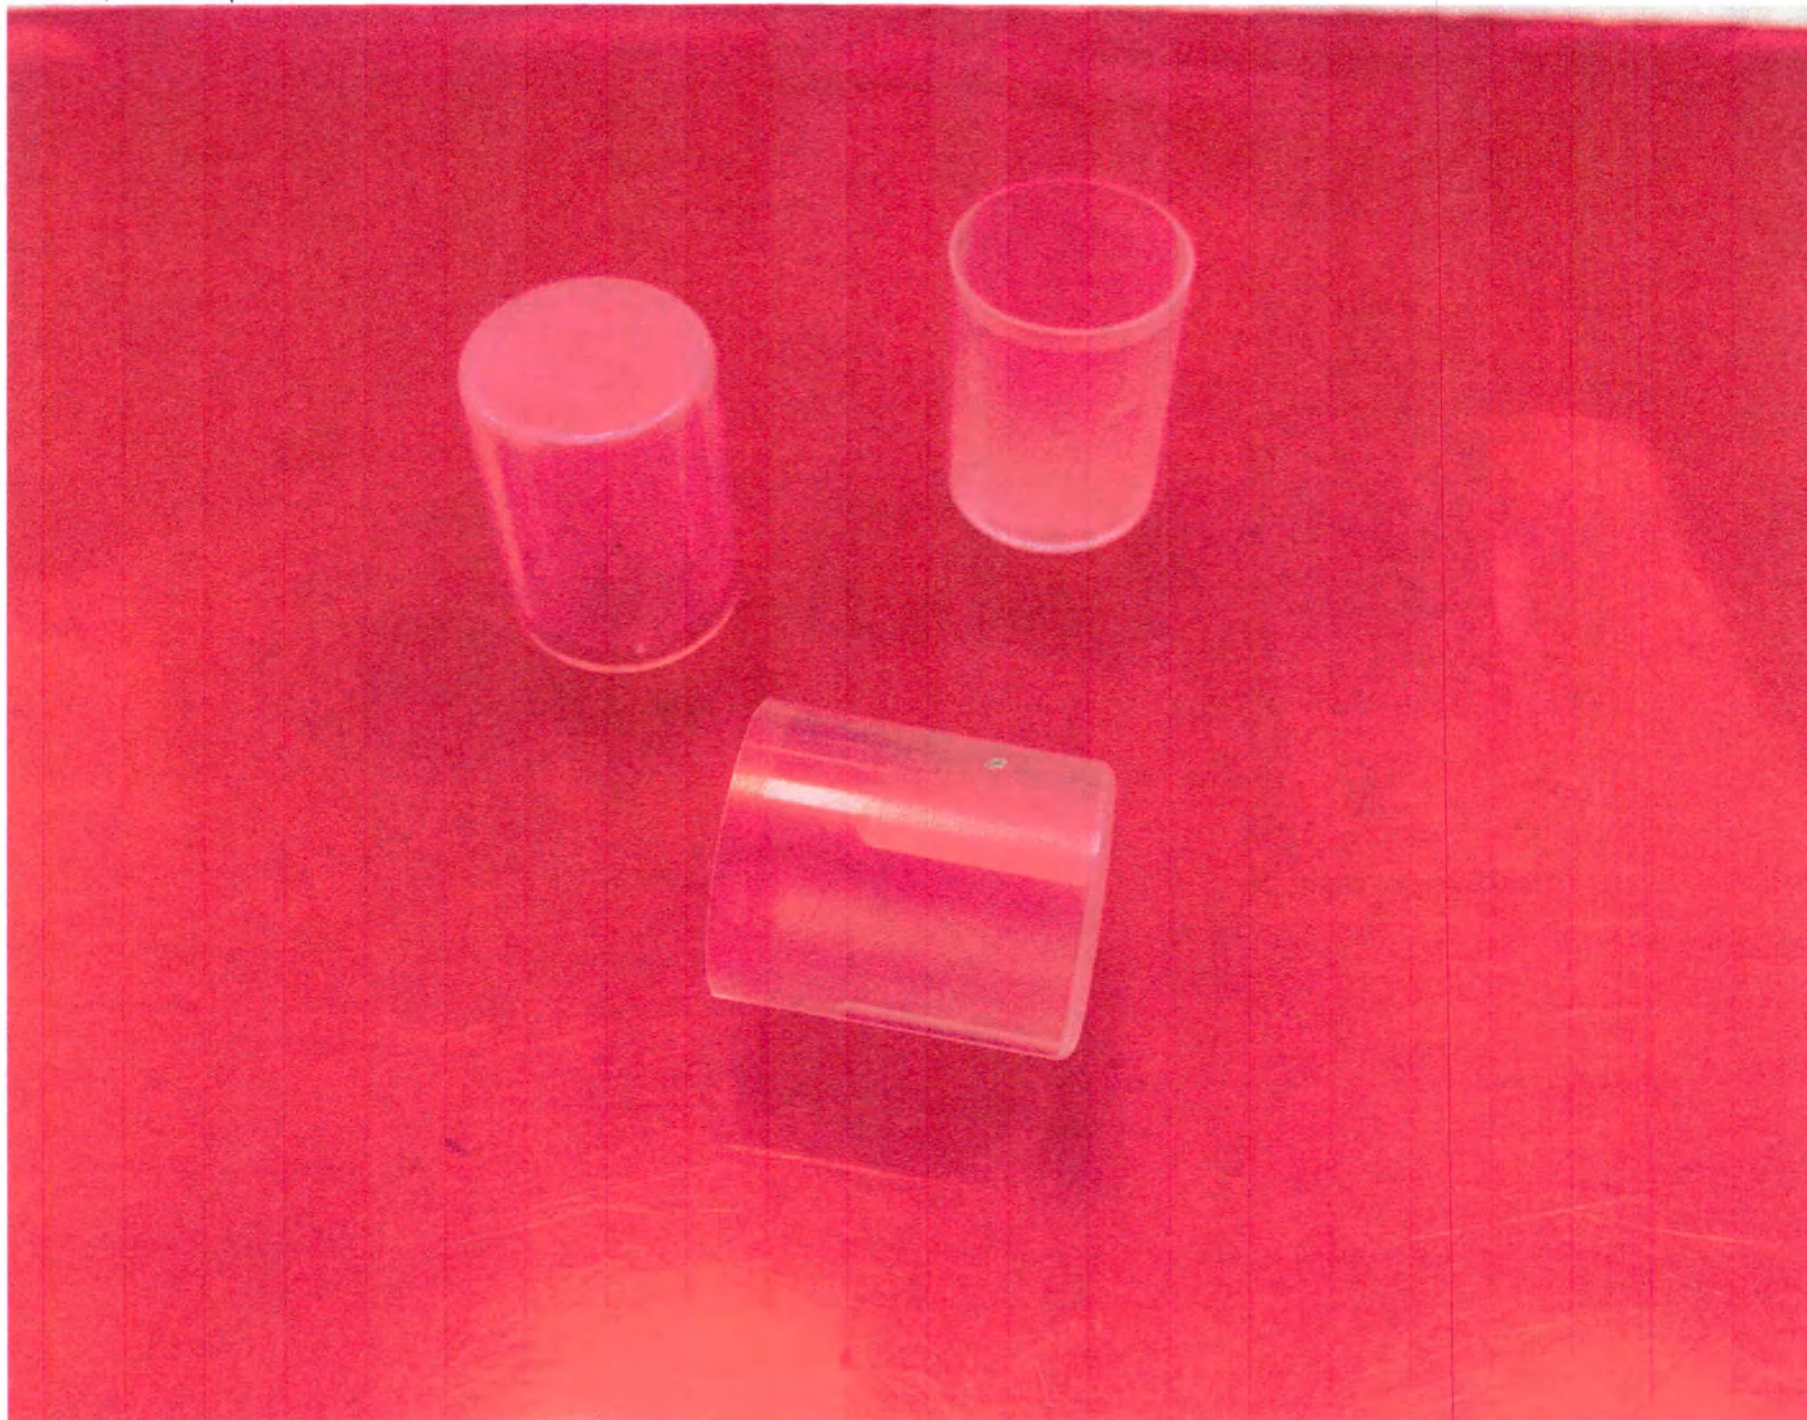

6. Кабель соединительный для держателя камеры - 3 м или 5 м или 10 м.

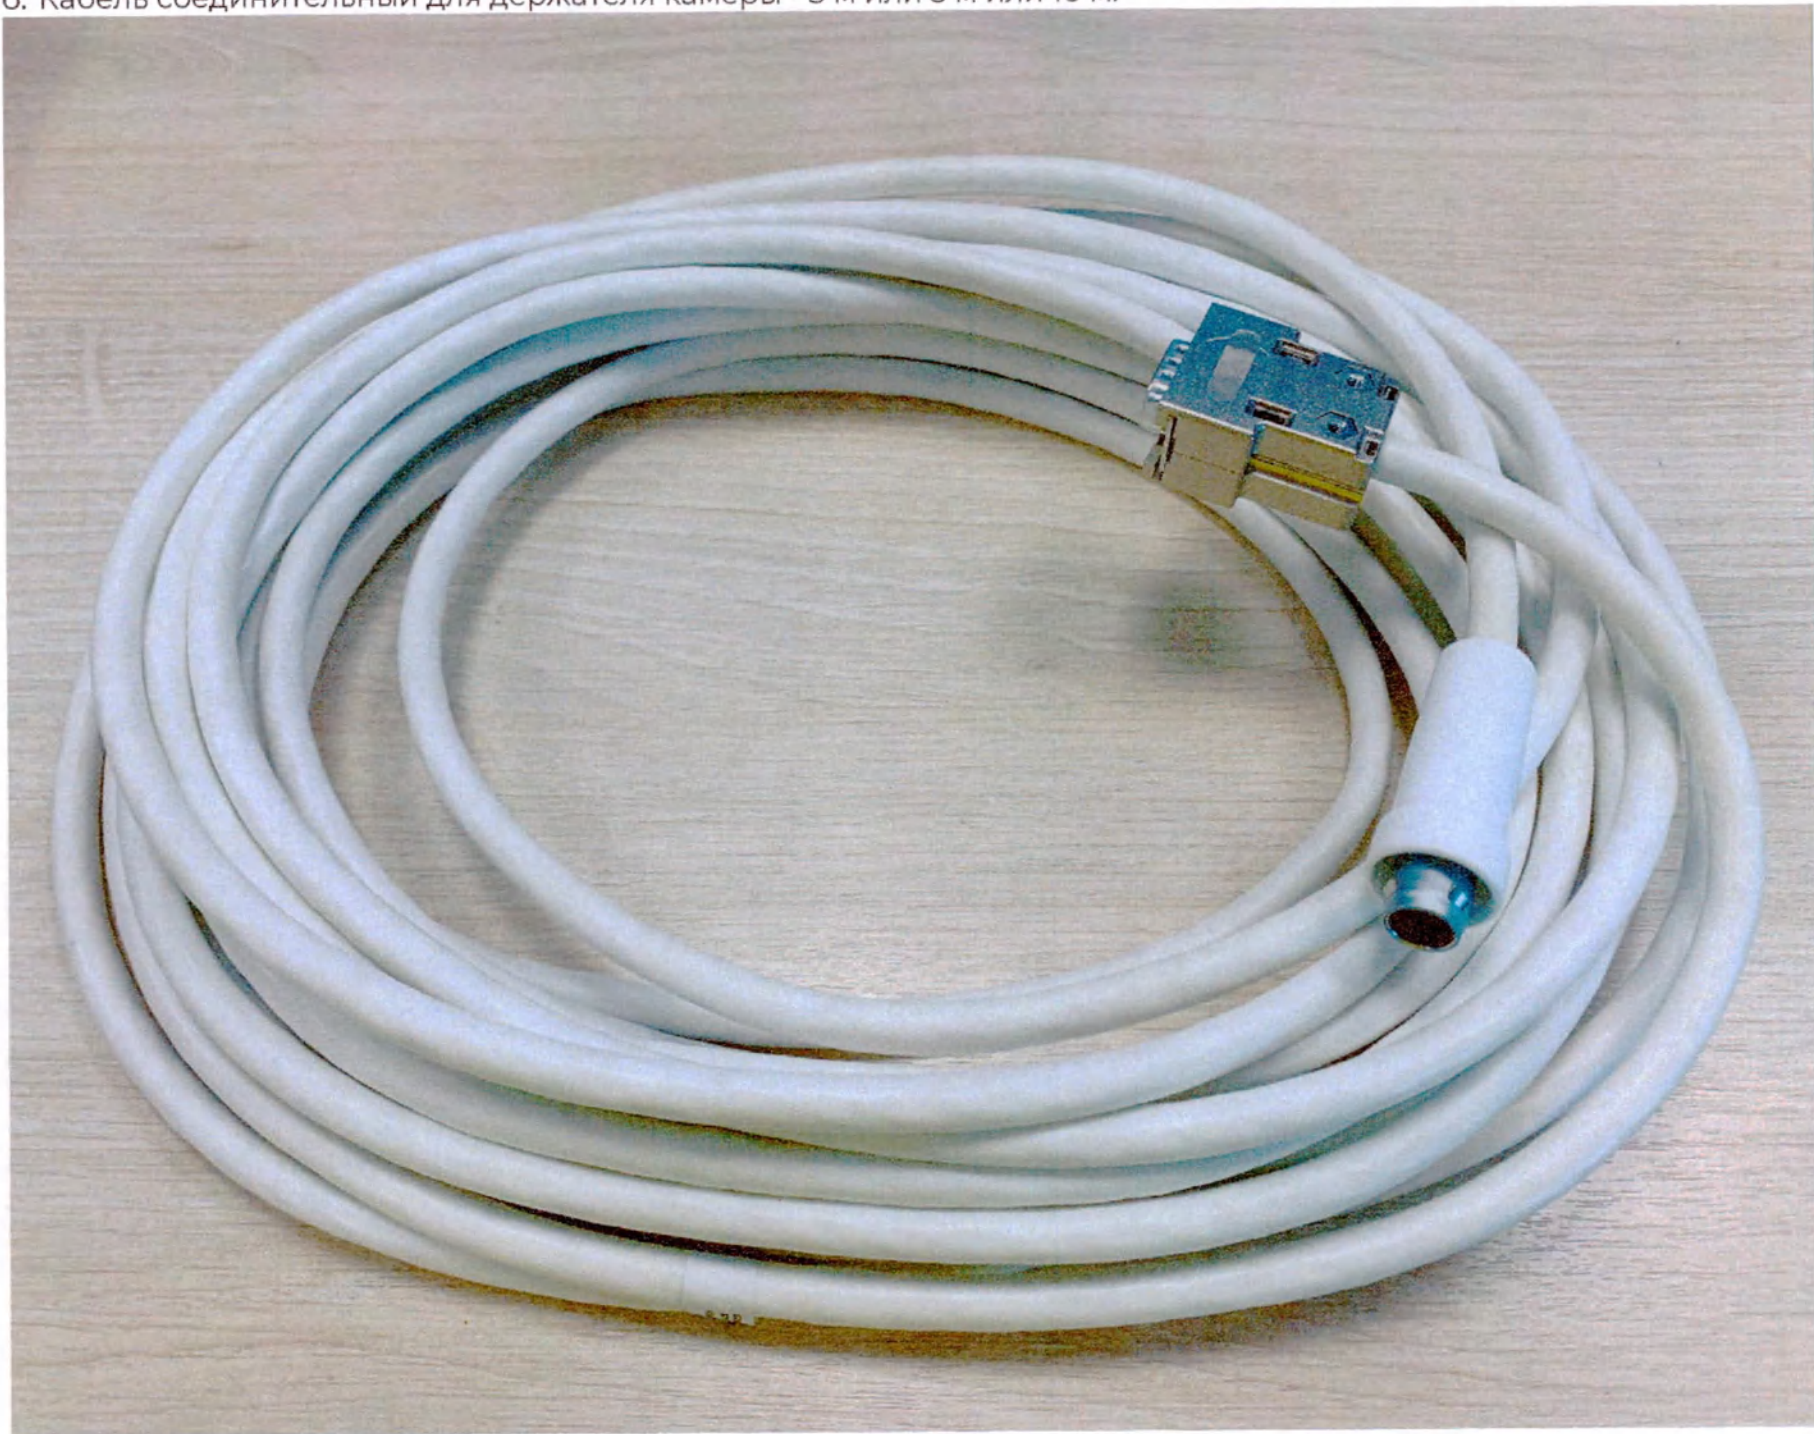

7. Кабель удлинительный для камеры



8. Кабель USB



9. Соединительная коробка





10. Медицинский блок питания




11. Кабель сетевой медицинского блока питания.





12. Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде

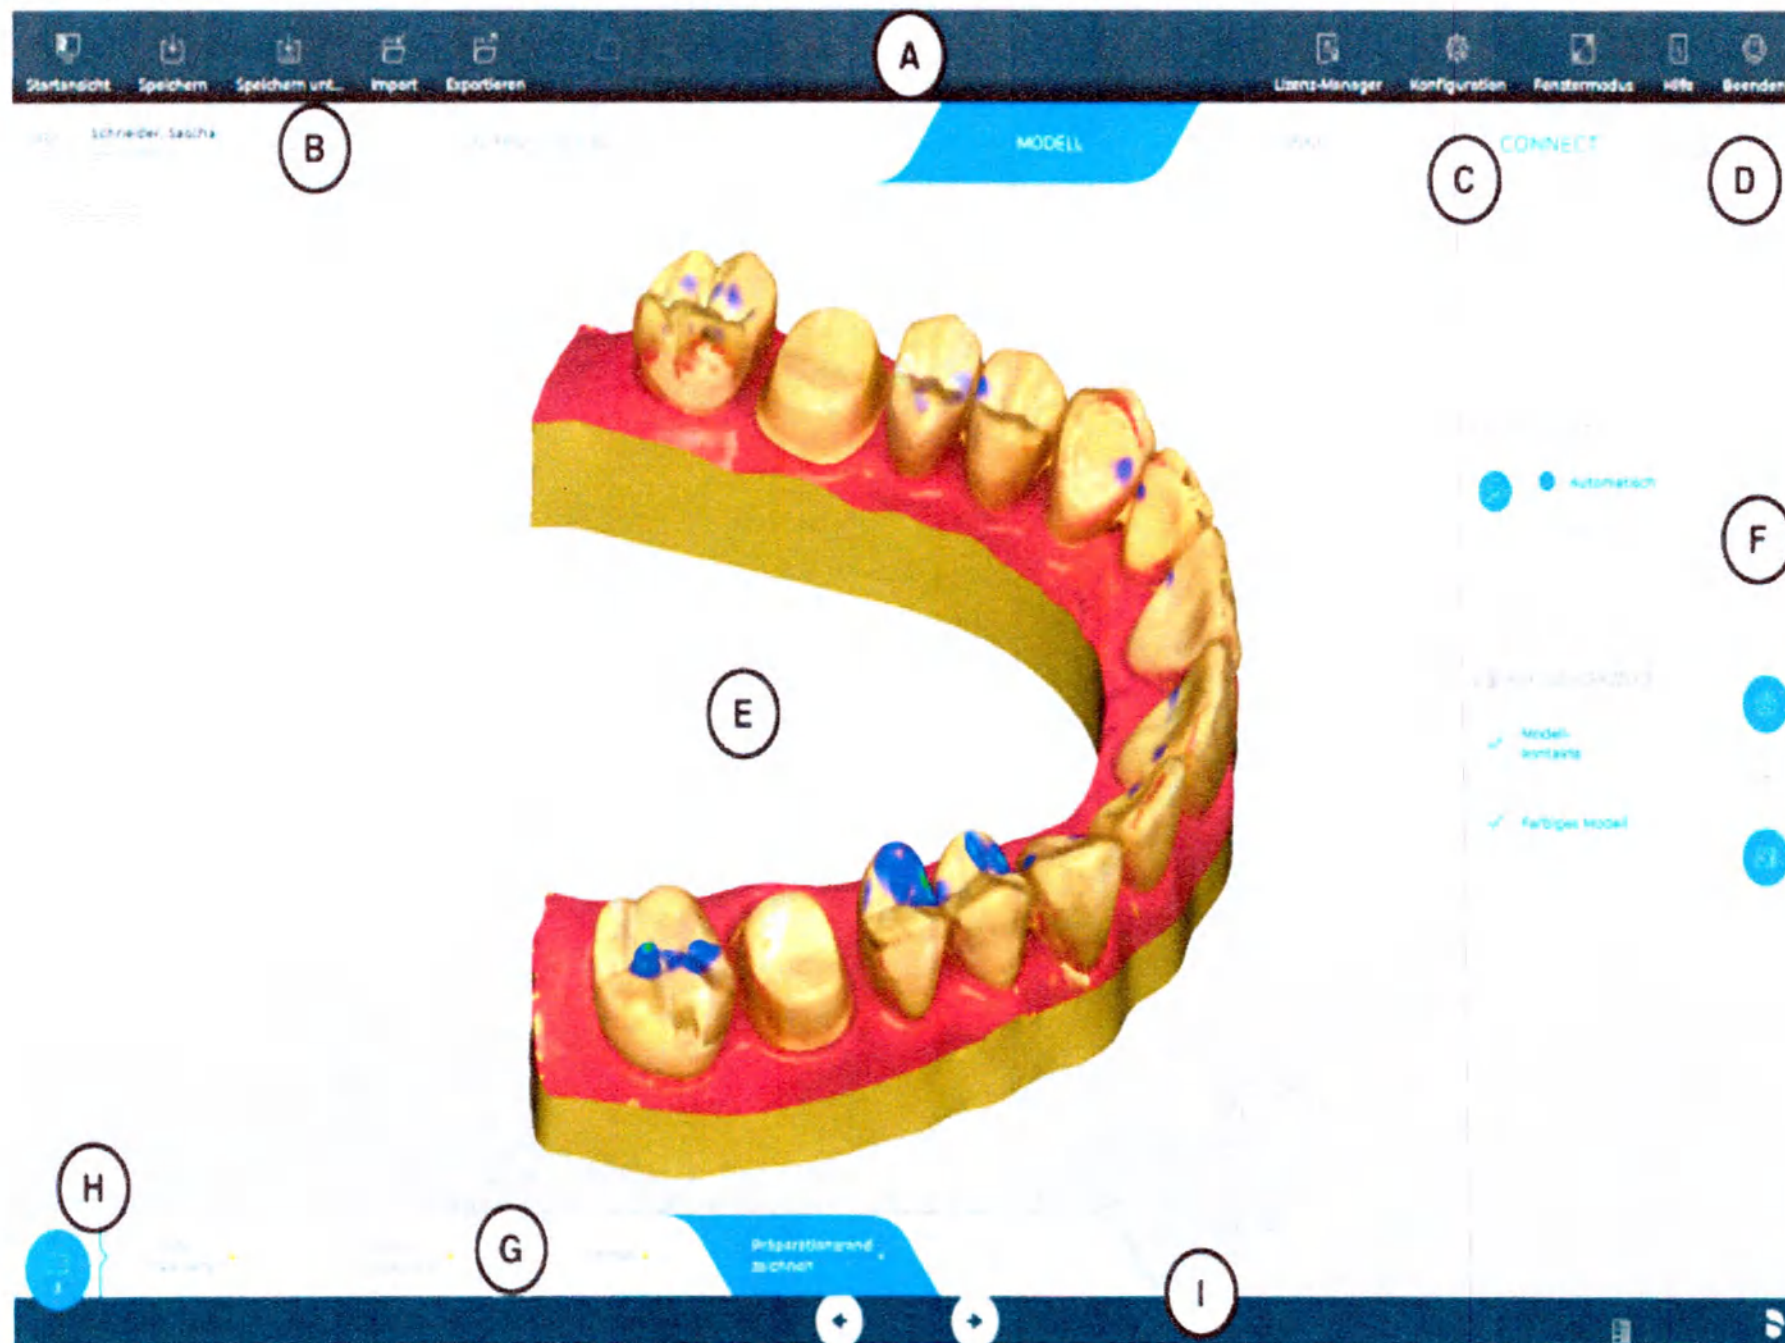

Обзор интерфейса


13. Программное обеспечение CEREC SW на электронном носителе



14. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе




15. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера

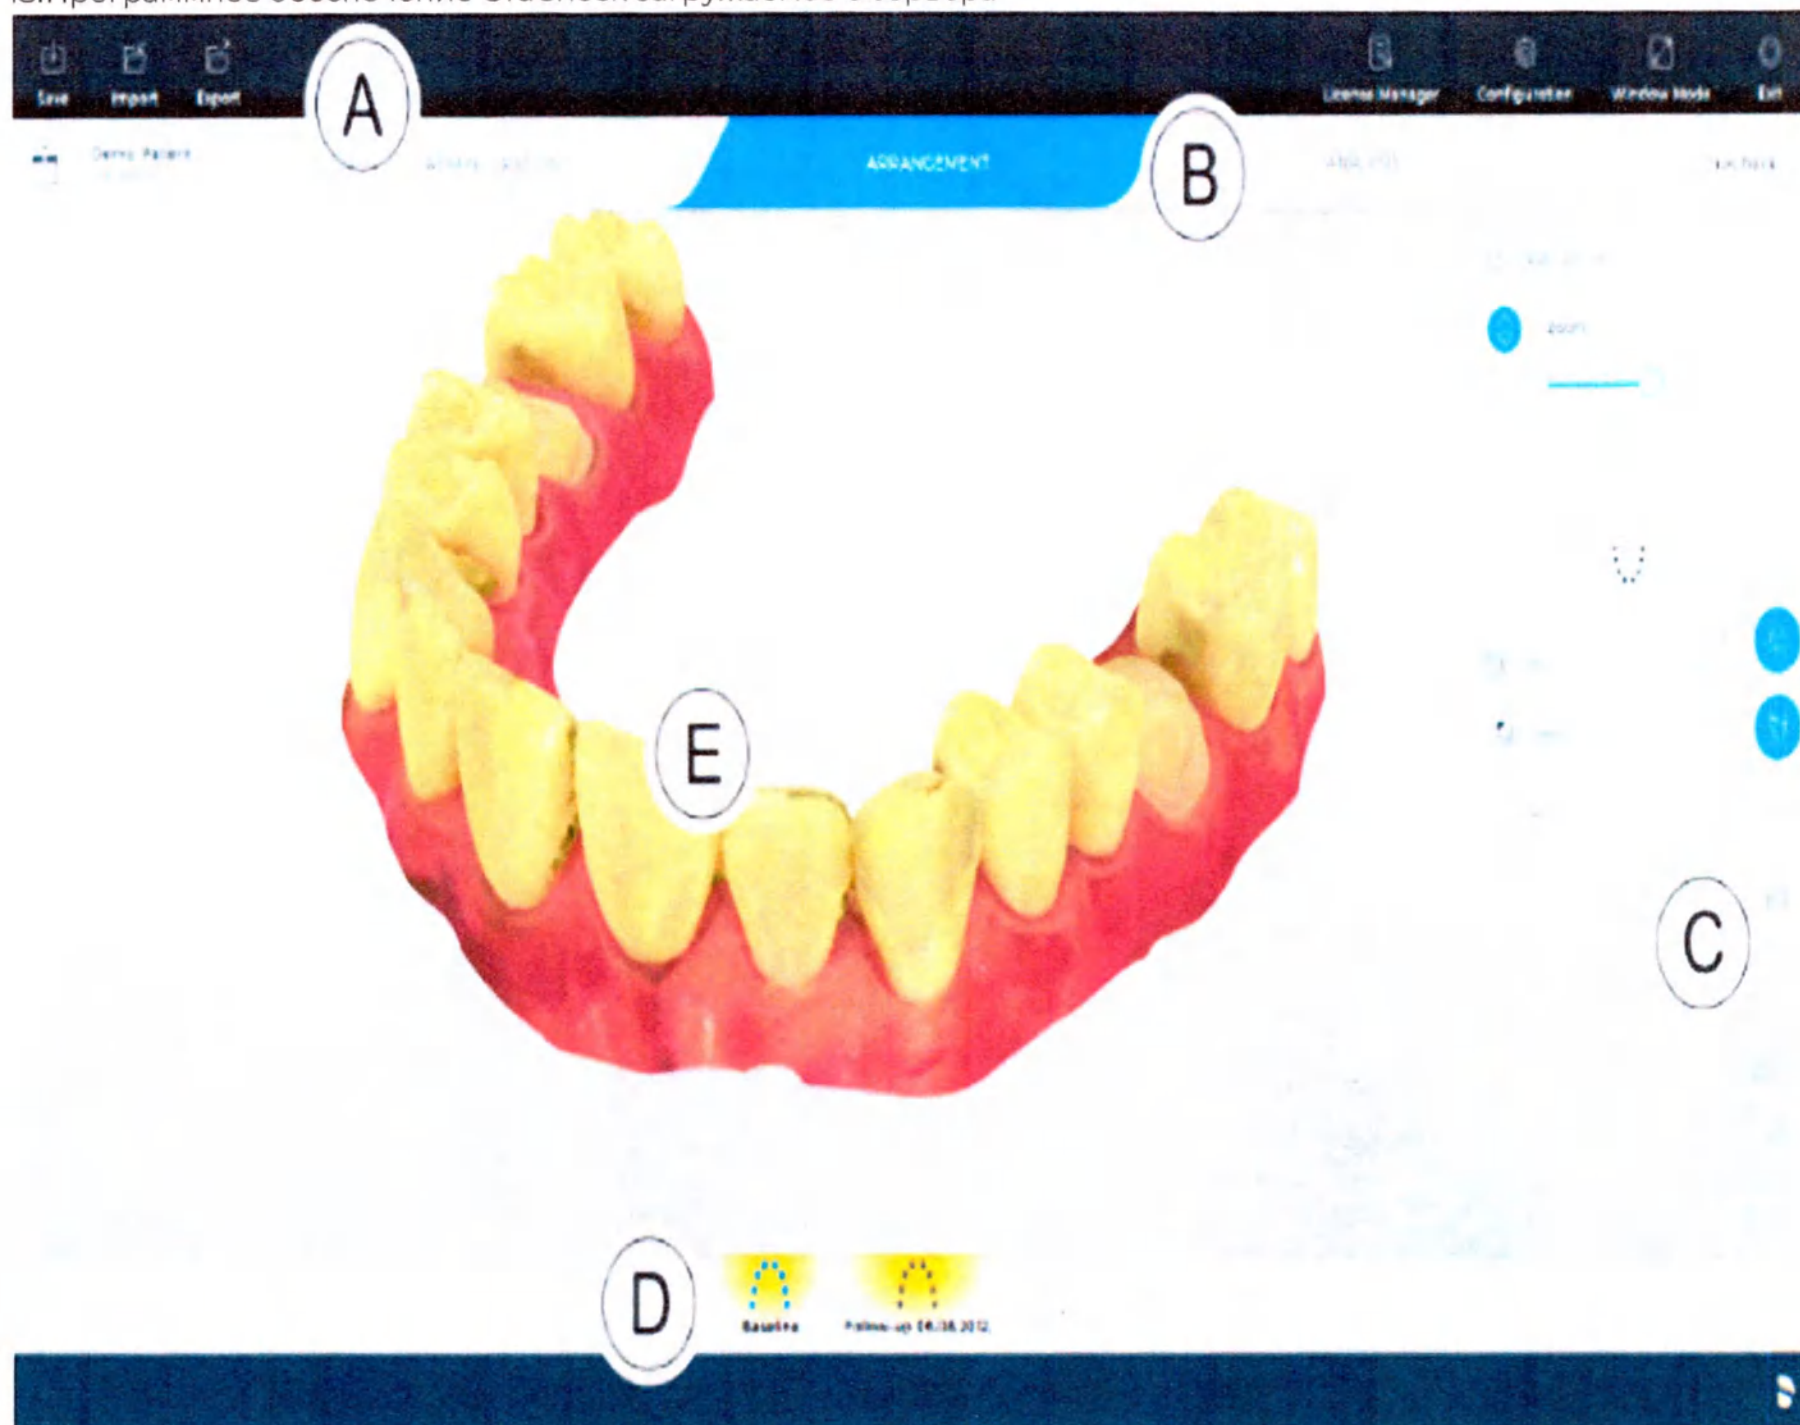

16. Лицензионные коды License Voucher.



17.USB носитель с программными лицензиями

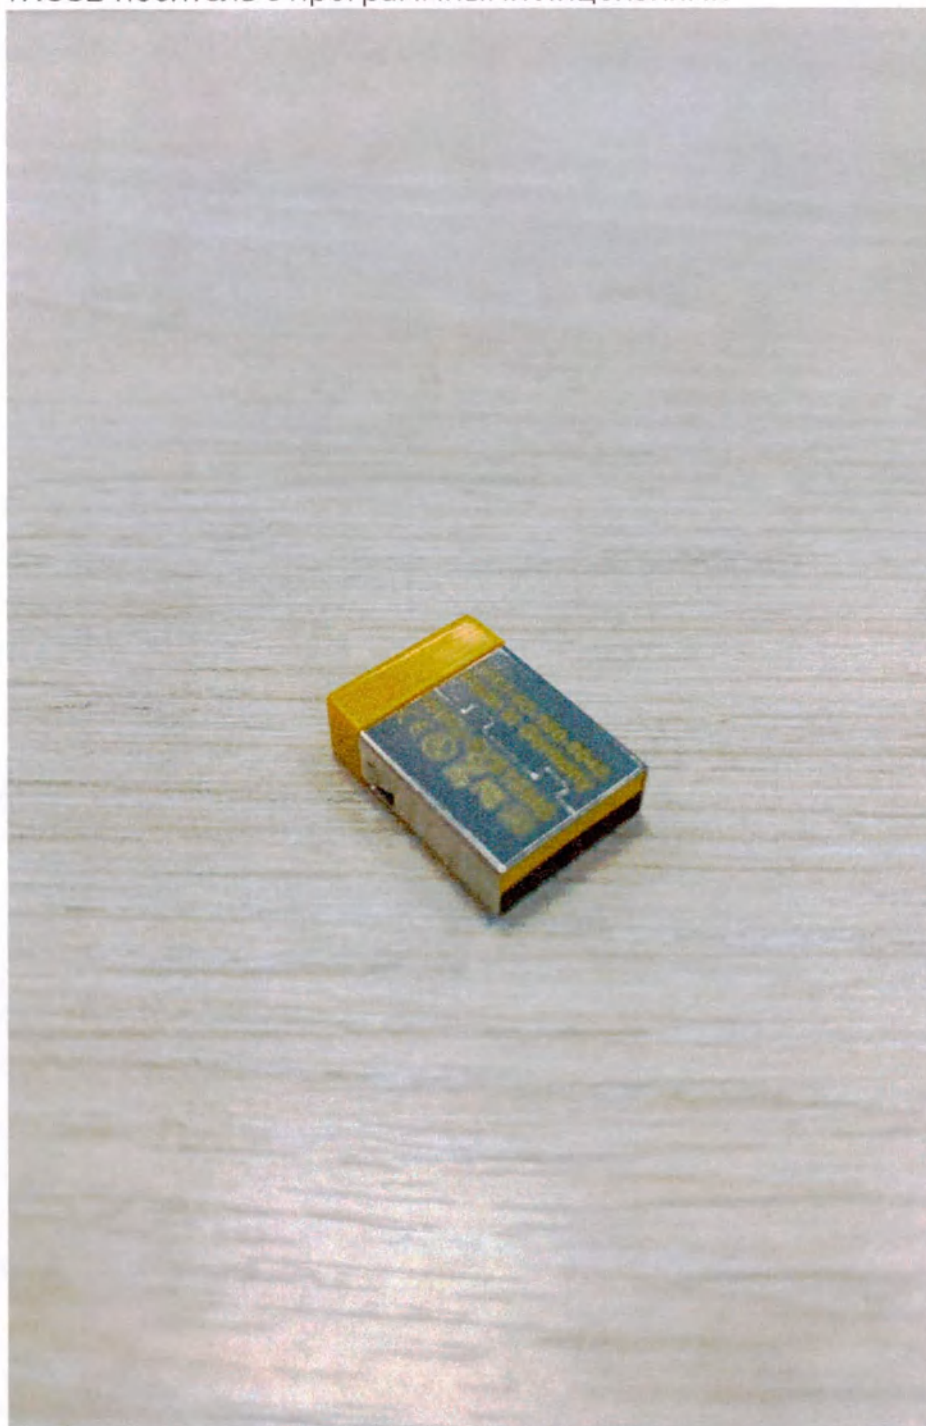

18. Одноразовые утилизируемые гигиенические защитные чехлы для планшета



19. Стойка планшета для стола





21. Антенны WiFi адаптера ПК



22. Кабель сетевой питания ПК




23. Клавиатура и мышь






25. Программный модуль для тестирования работы ПК (PC Diagnostic tool)

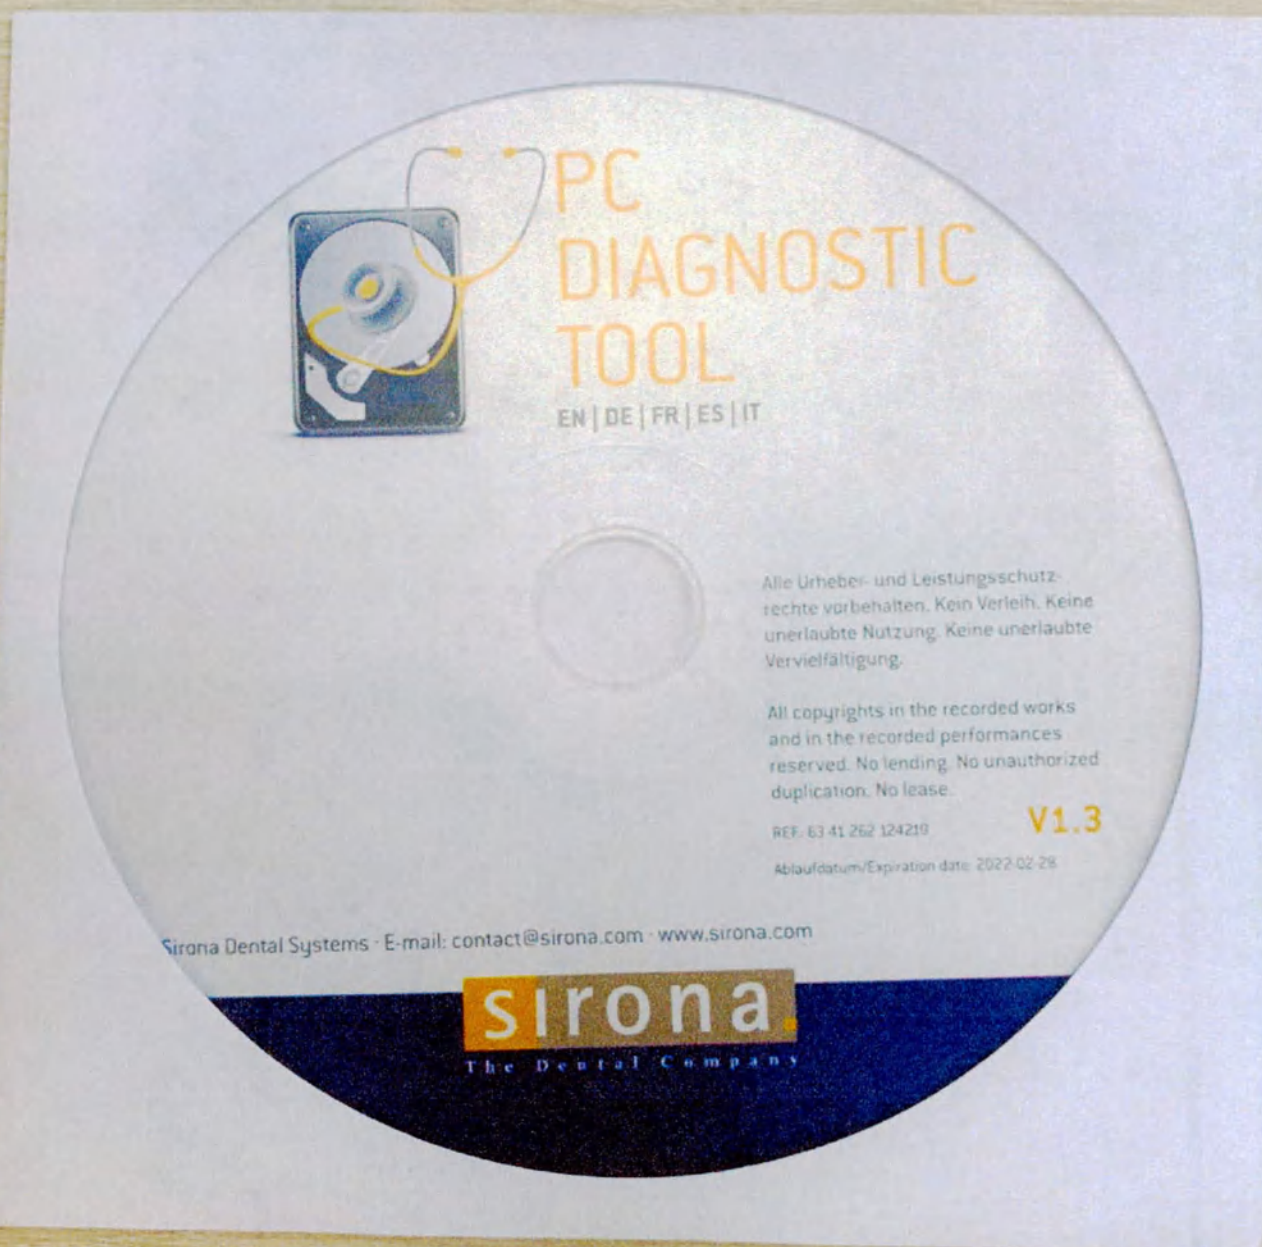

26. Программный модуль для сброса настроек ПК к заводским (Dentsply Sirona Restore Solution)




27. Программный модуль для удаленной передачи изображения с монитора ПК на планшет (Sirona Remote)

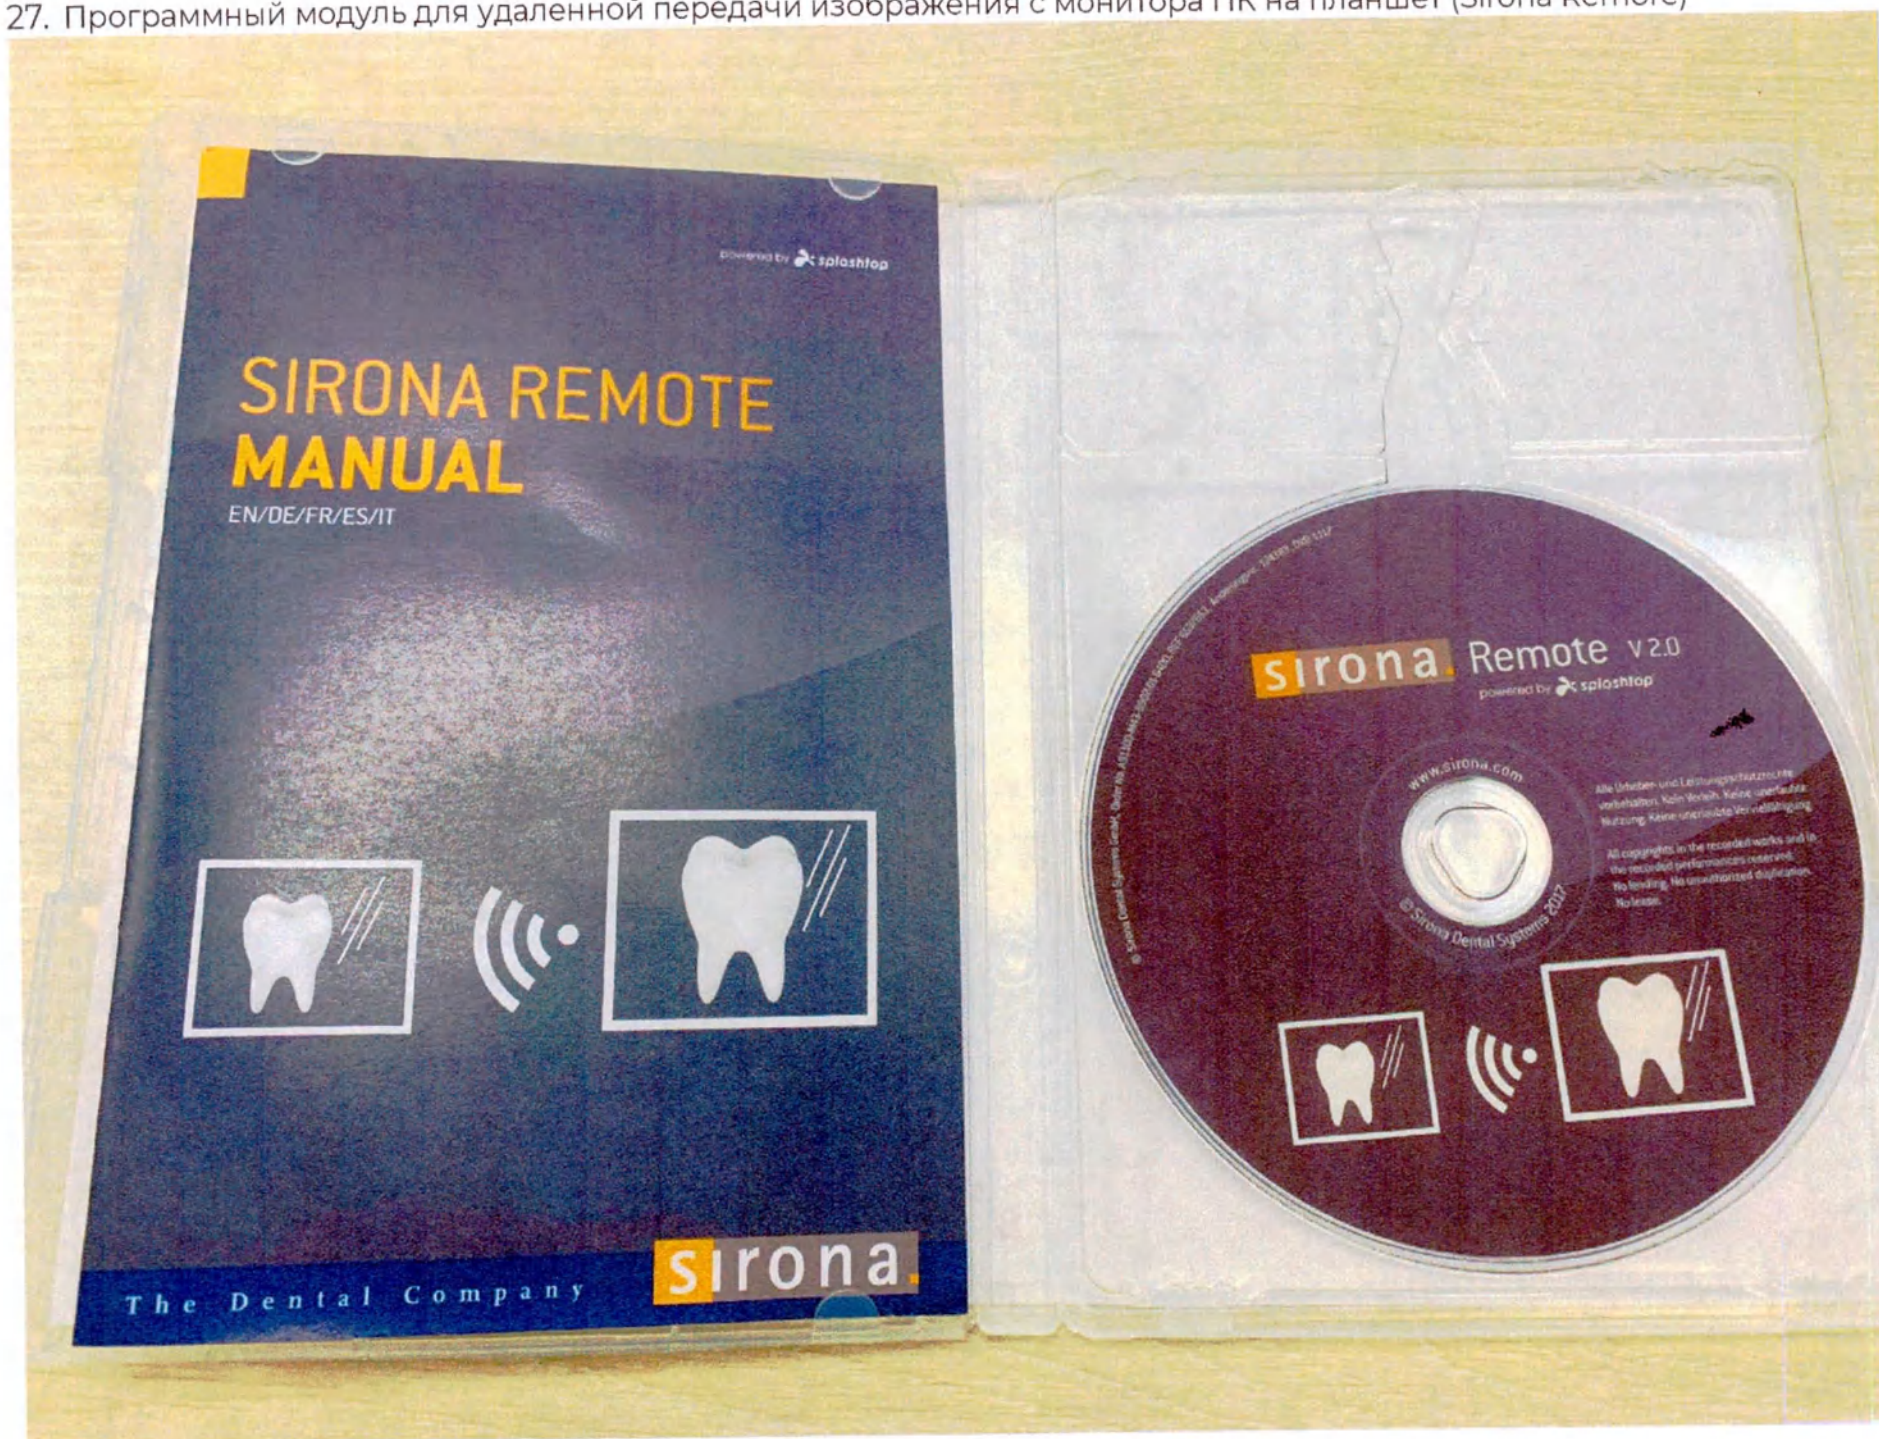



REF 64 34 505
REV 125 598

Dentsply Sirona
Fabrikstrasse 31
64625 Bensheim
Germany
E-Mail: contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com



 Dentsply
Sirona

VI. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Connect Omnicam:



1. Камера внутриротовая Omnicam (CEREC Omnicam)



2. Держатель камеры




3. Насадка калибровочная для настройки точности






4. Насадка калибровочная для настройки цвета

5. Защитные крышки

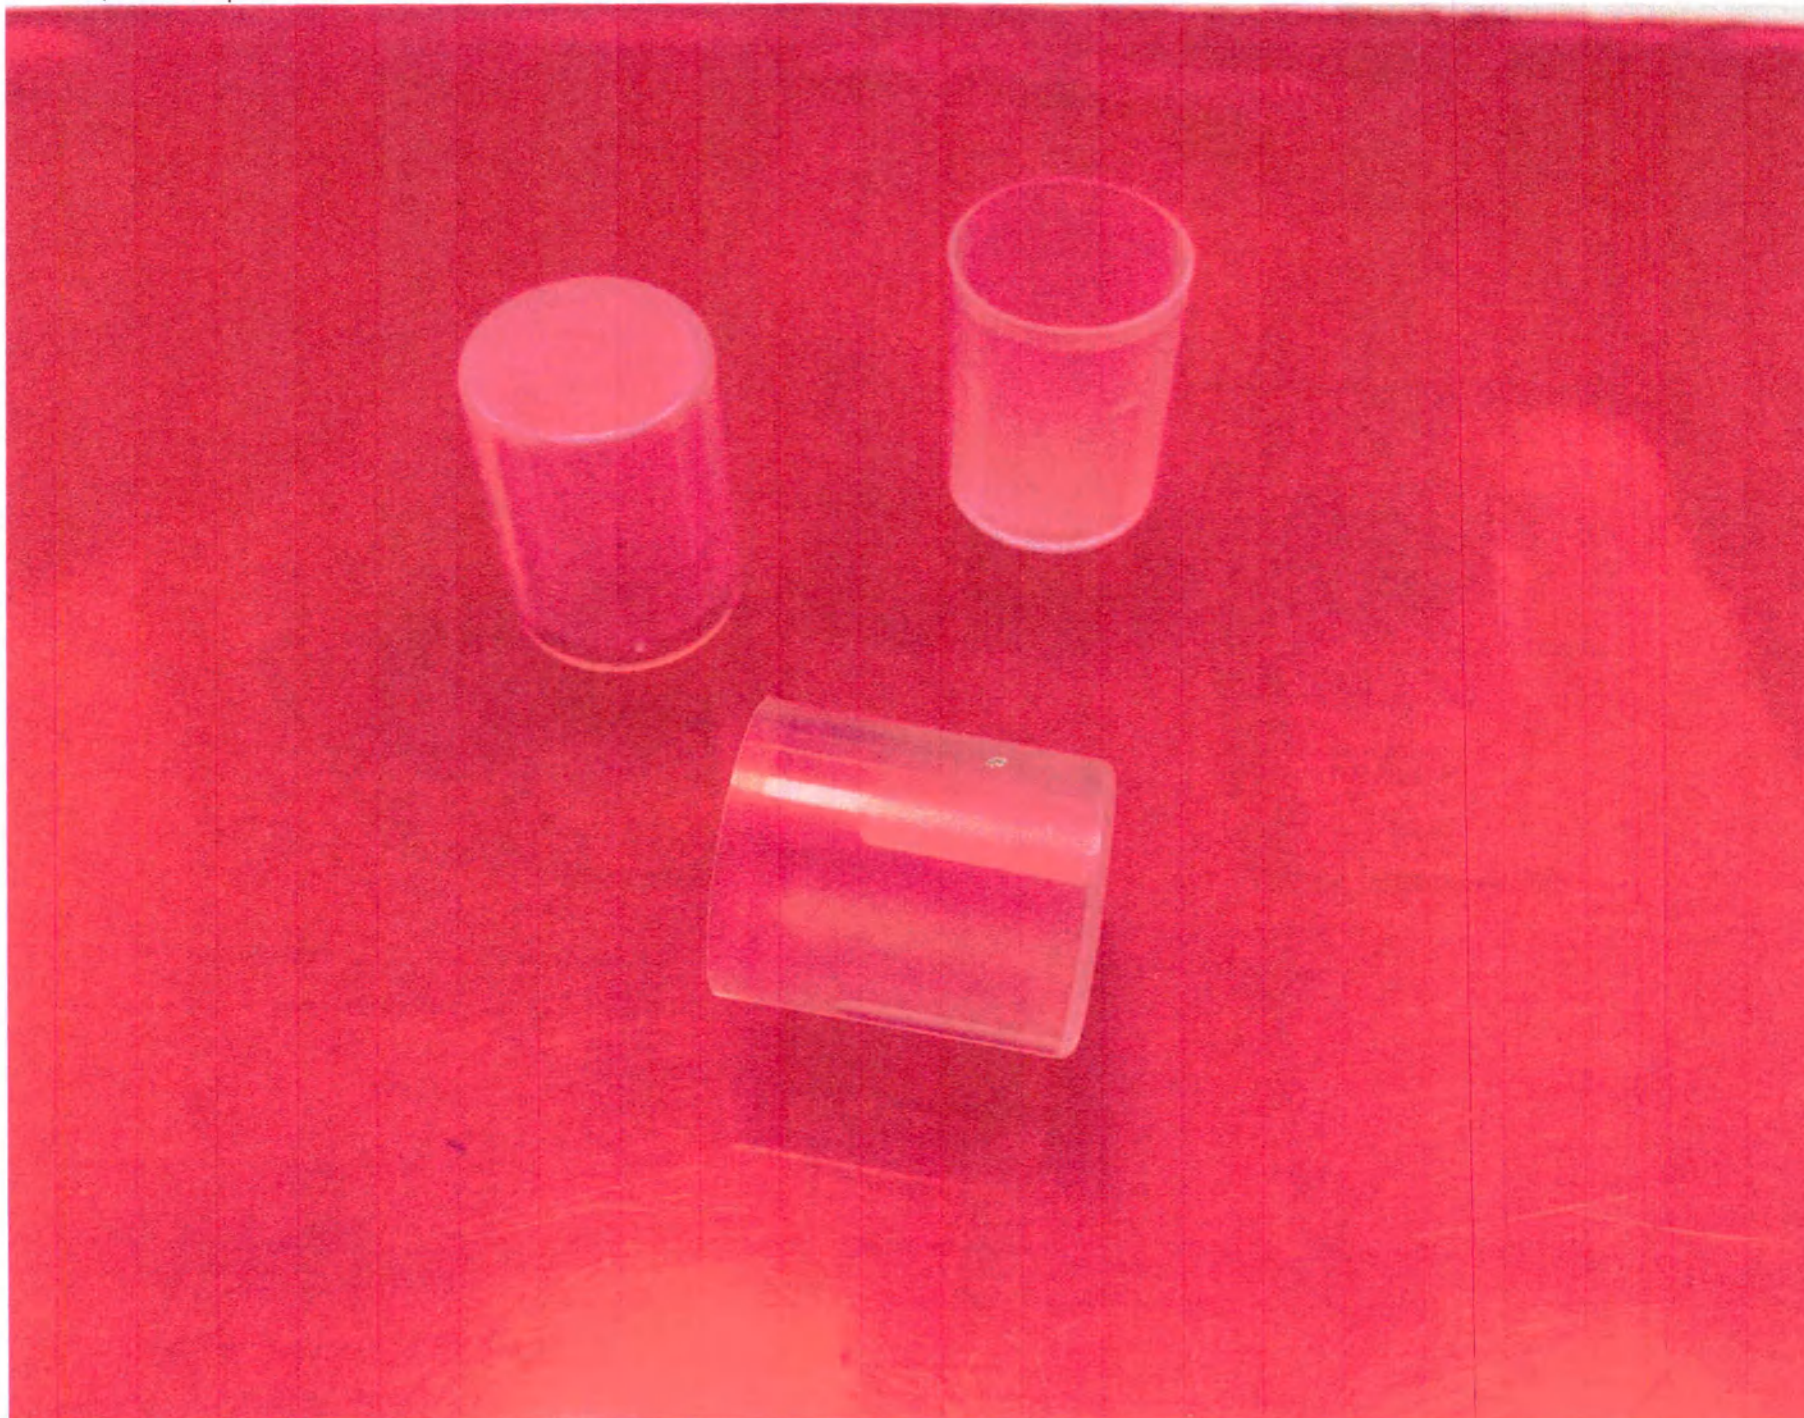

6. Кабель соединительный для держателя камеры - 3 м или 5 м или 10 м.

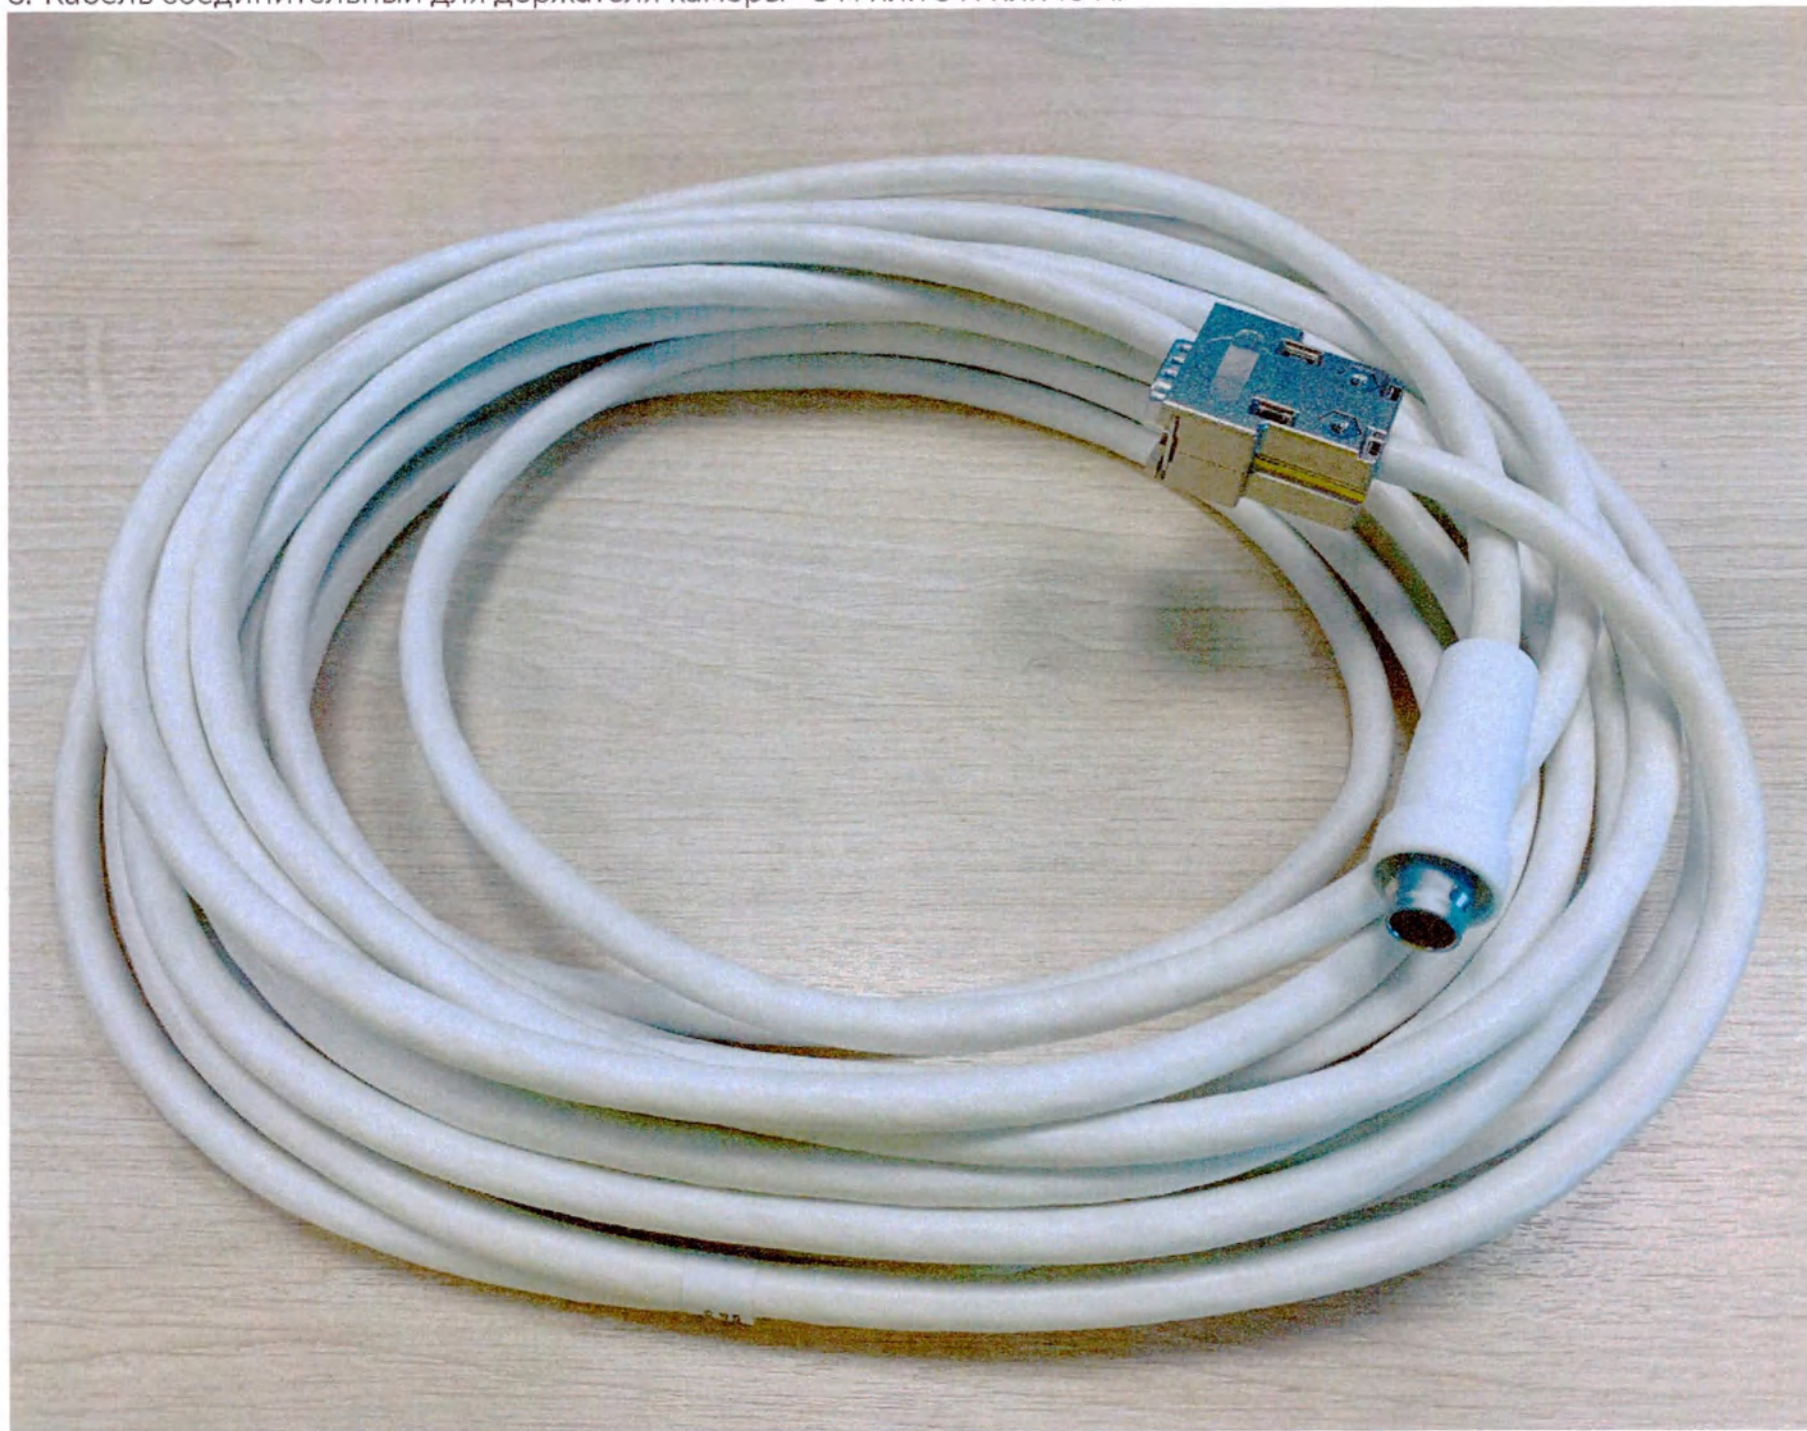

7. Кабель удлинительный для камеры



8. Кабель USB



9. Соединительная коробка Connect



10. Медицинский блок питания




11. Кабель сетевой медицинской блока питания.





12. Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде

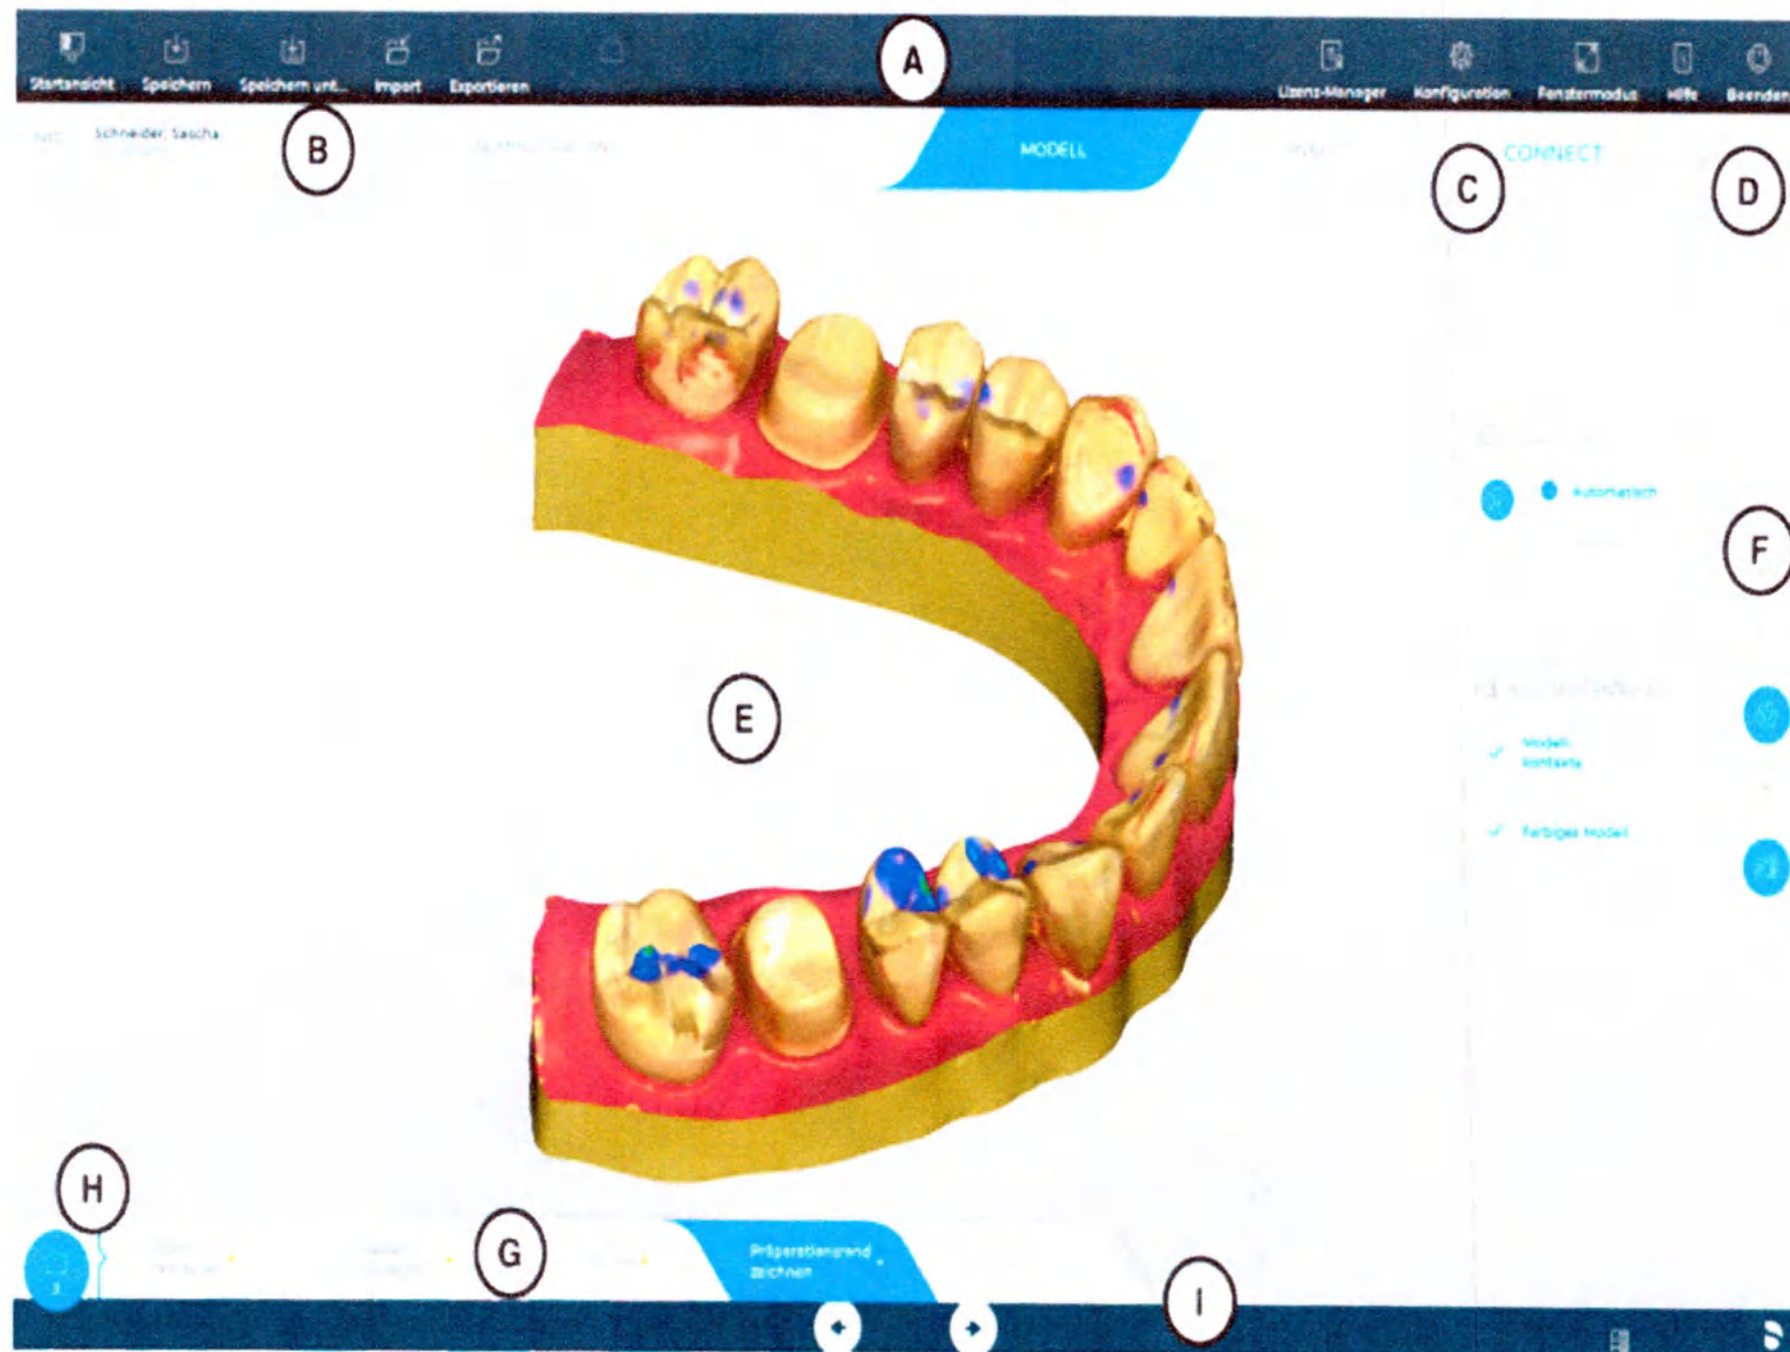


Обзор интерфейса

13. Программное обеспечение CEREC Ortho SW на электронном носителе



14. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера

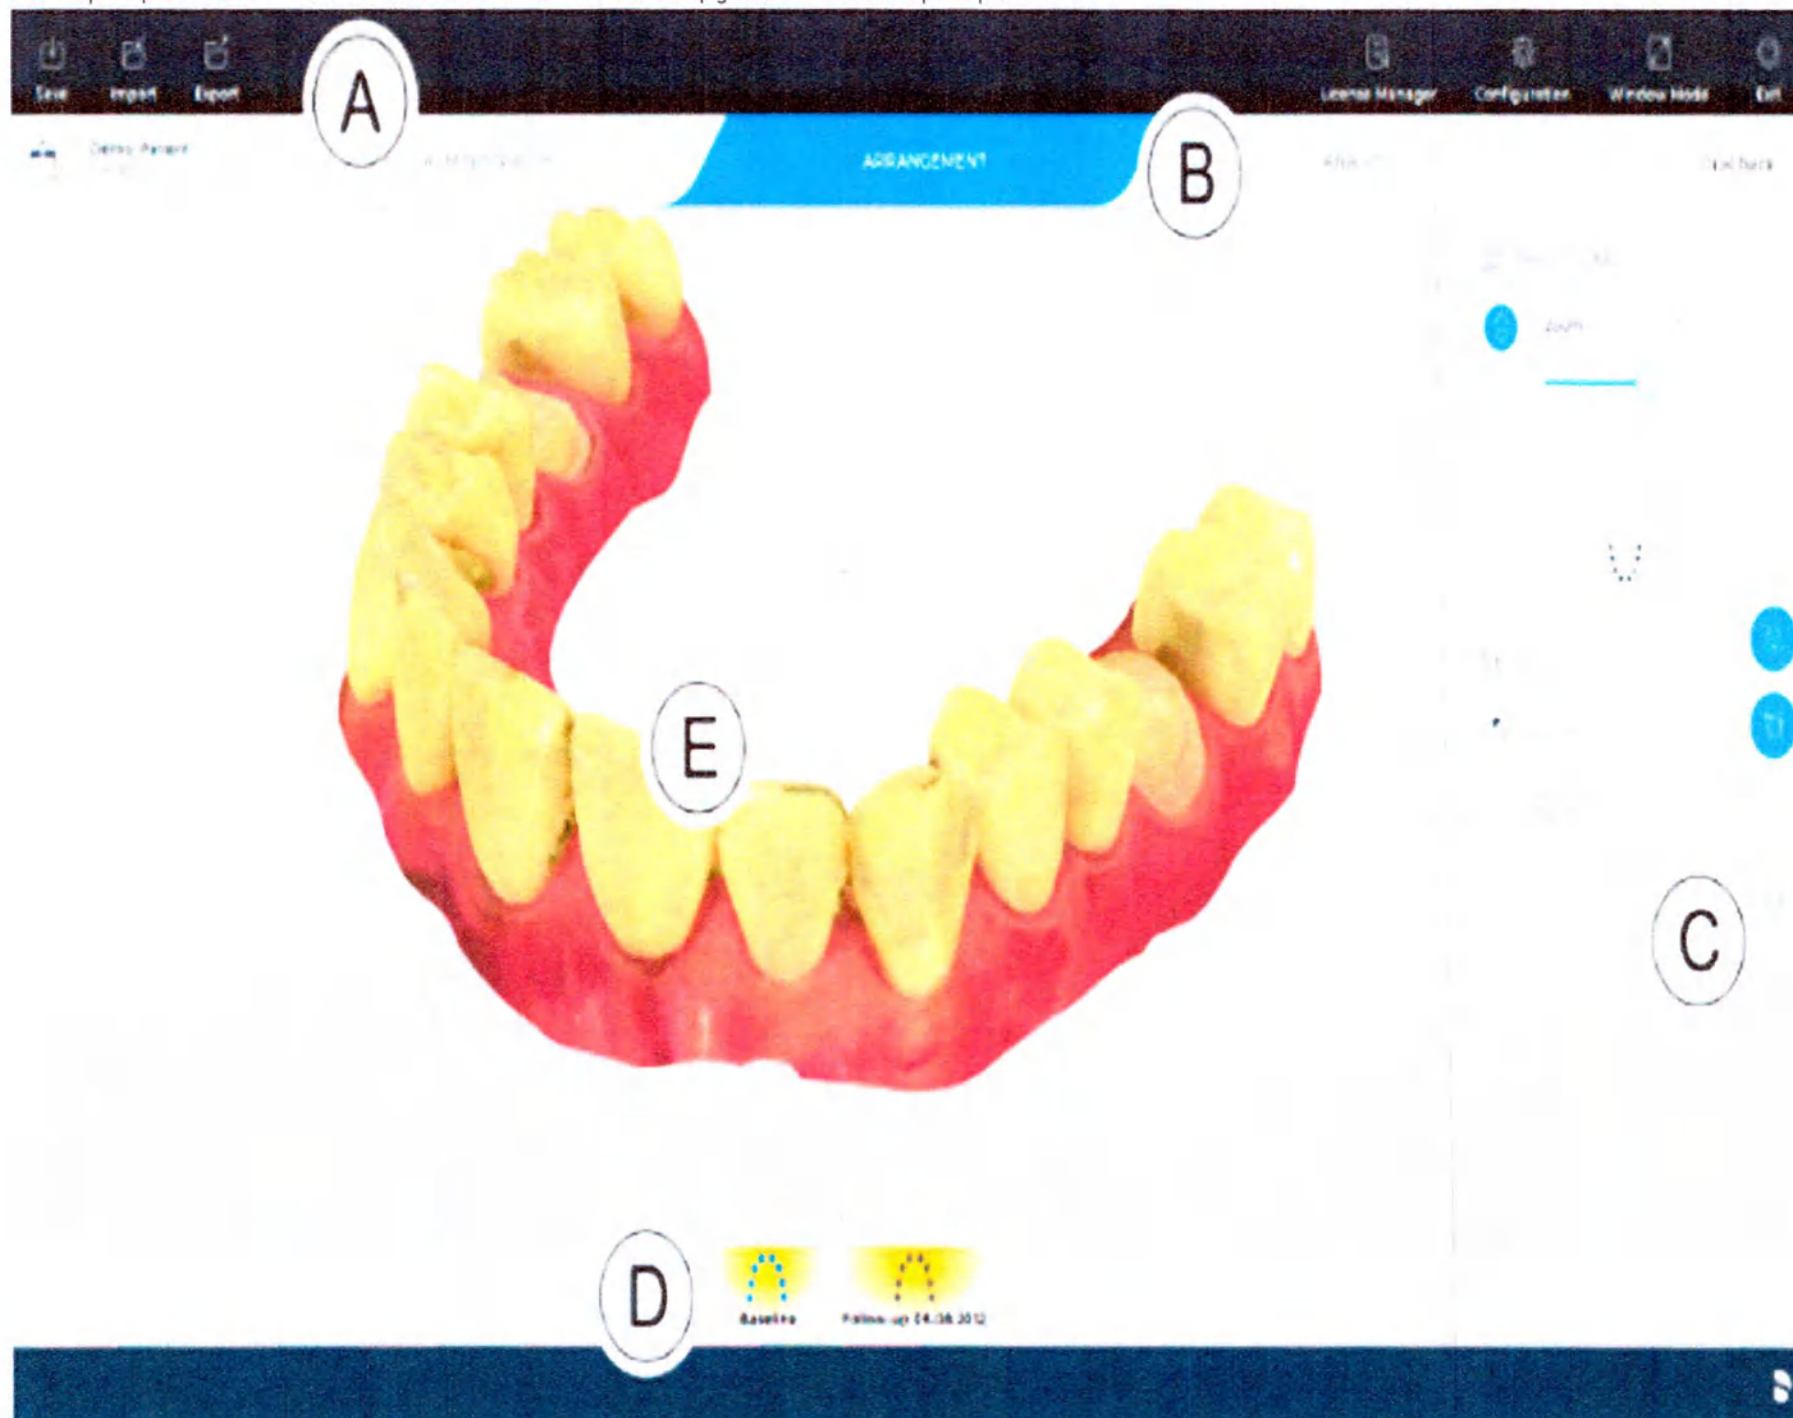

15. Лицензионные коды License Voucher.



16. USB носитель с программными лицензиями




17. Одноразовые утилизируемые гигиенические защитные чехлы для планшета



18. Стойка планшета для стола




19. ПК специальный

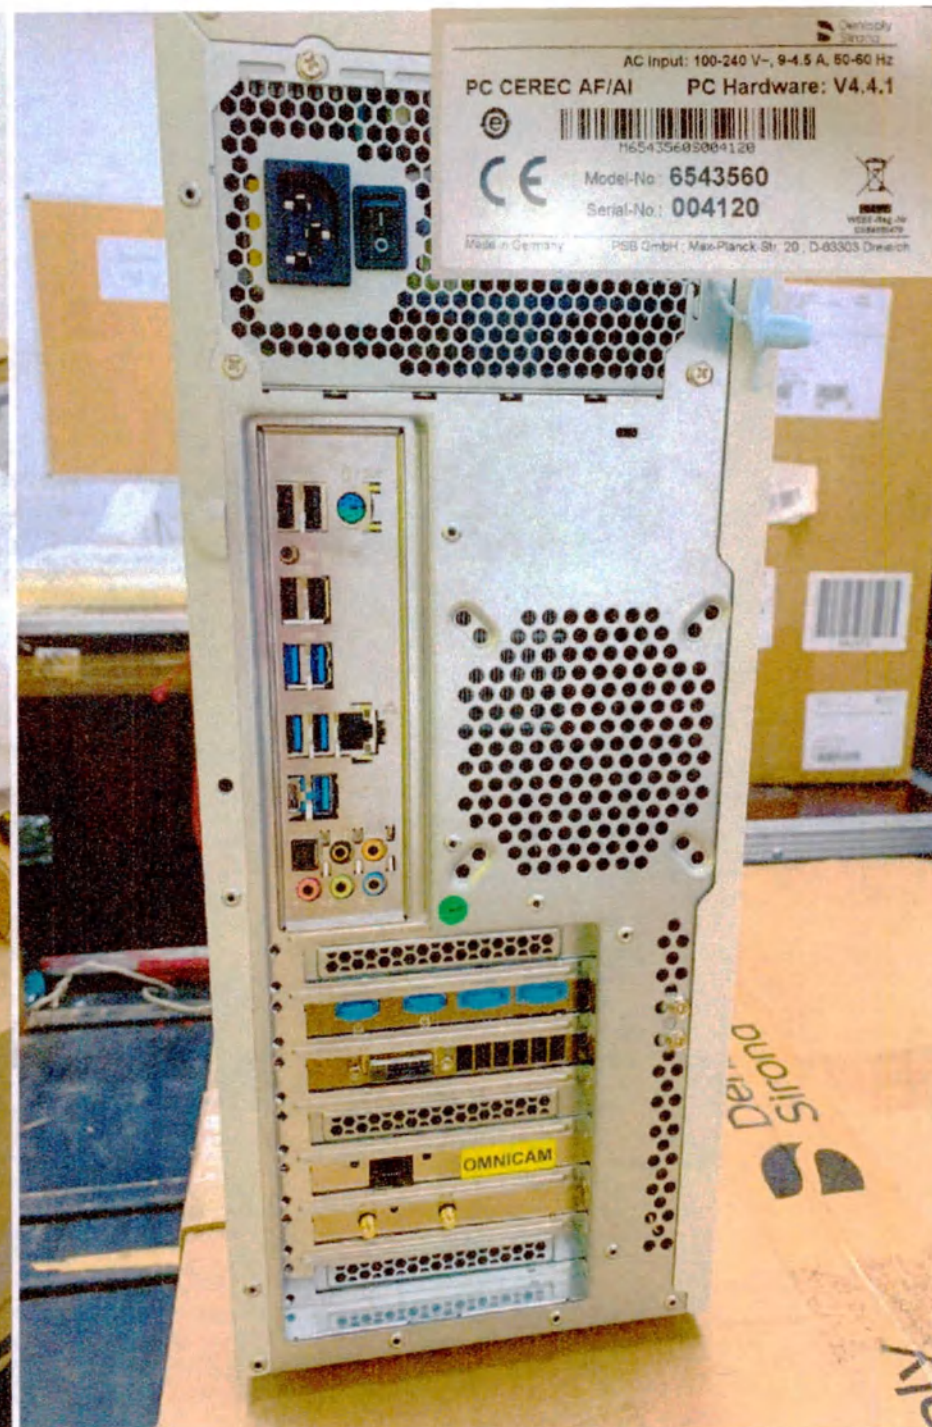






22. Клавиатура и мышь

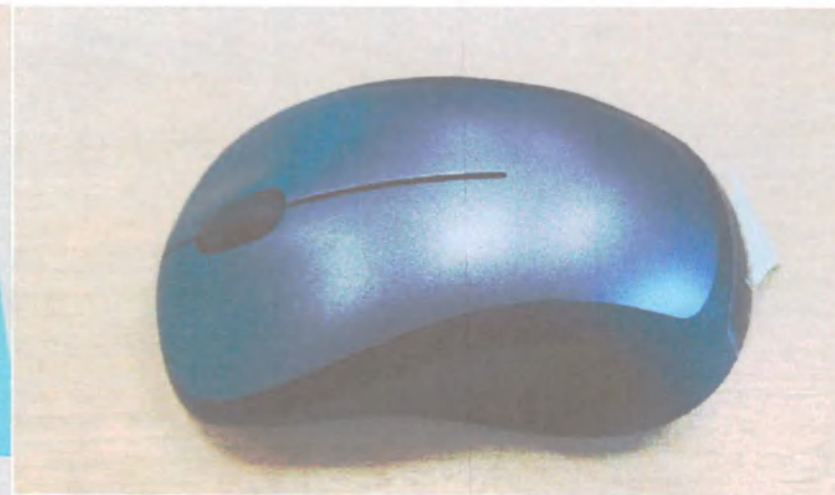


23. Кабель ЛВС (LAN) для ПК




24. Программный модуль для тестирования работы ПК (PC Diagnostic tool)

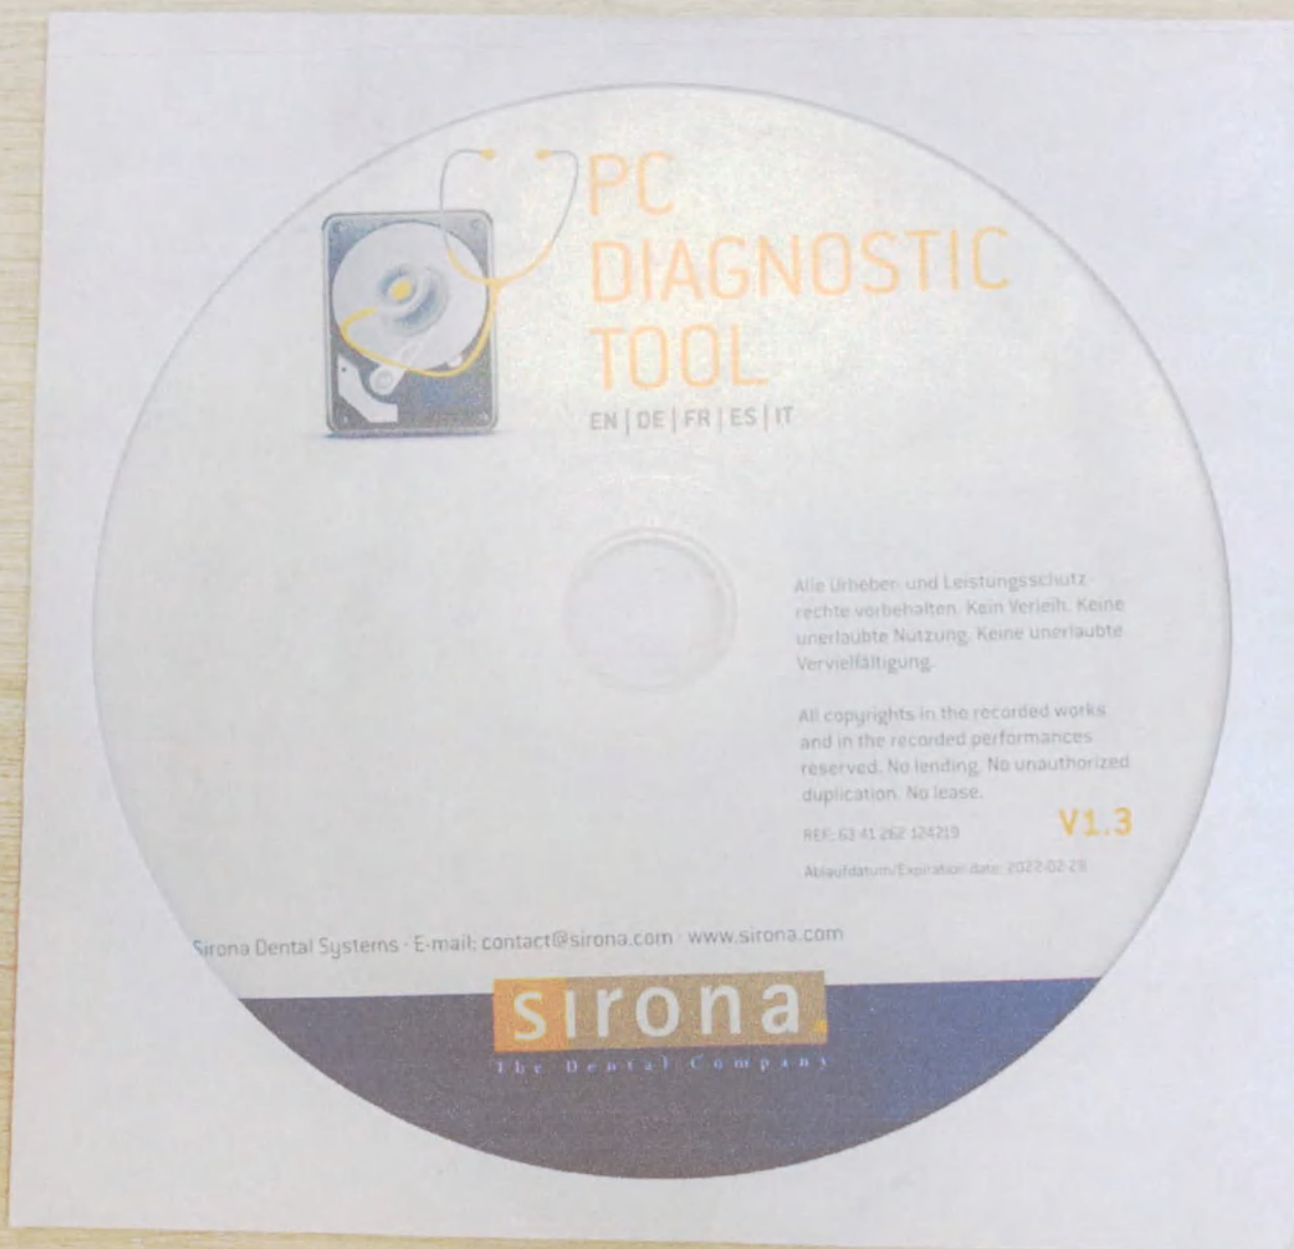

25. Программный модуль для сброса настроек ПК к заводским (Dentsply Sirona Restore Solution)

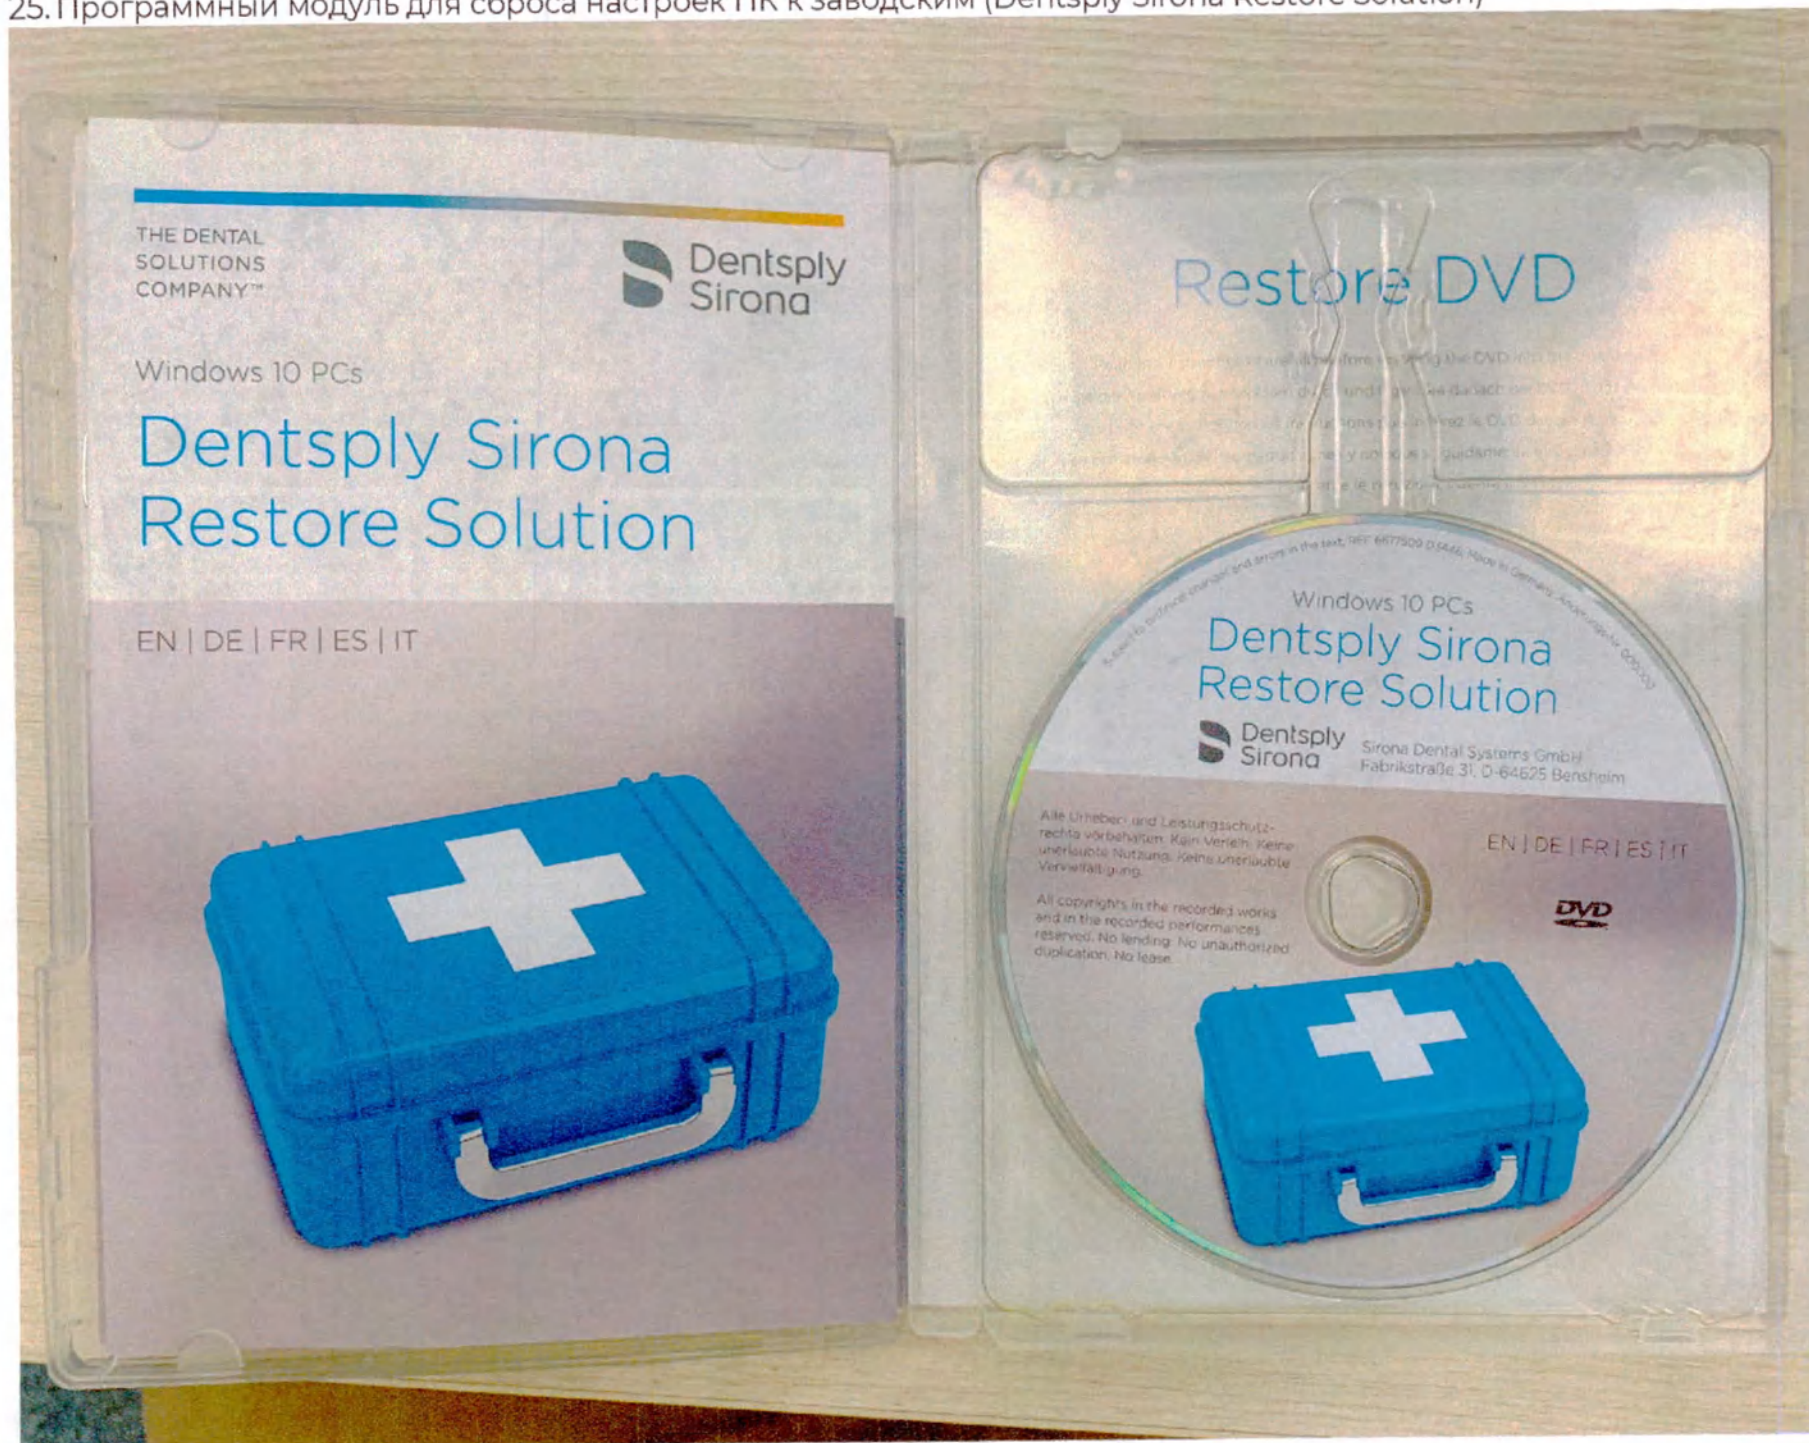

26. Программный модуль для удаленной передачи изображения с монитора ПК на планшет (Sirona Remote)

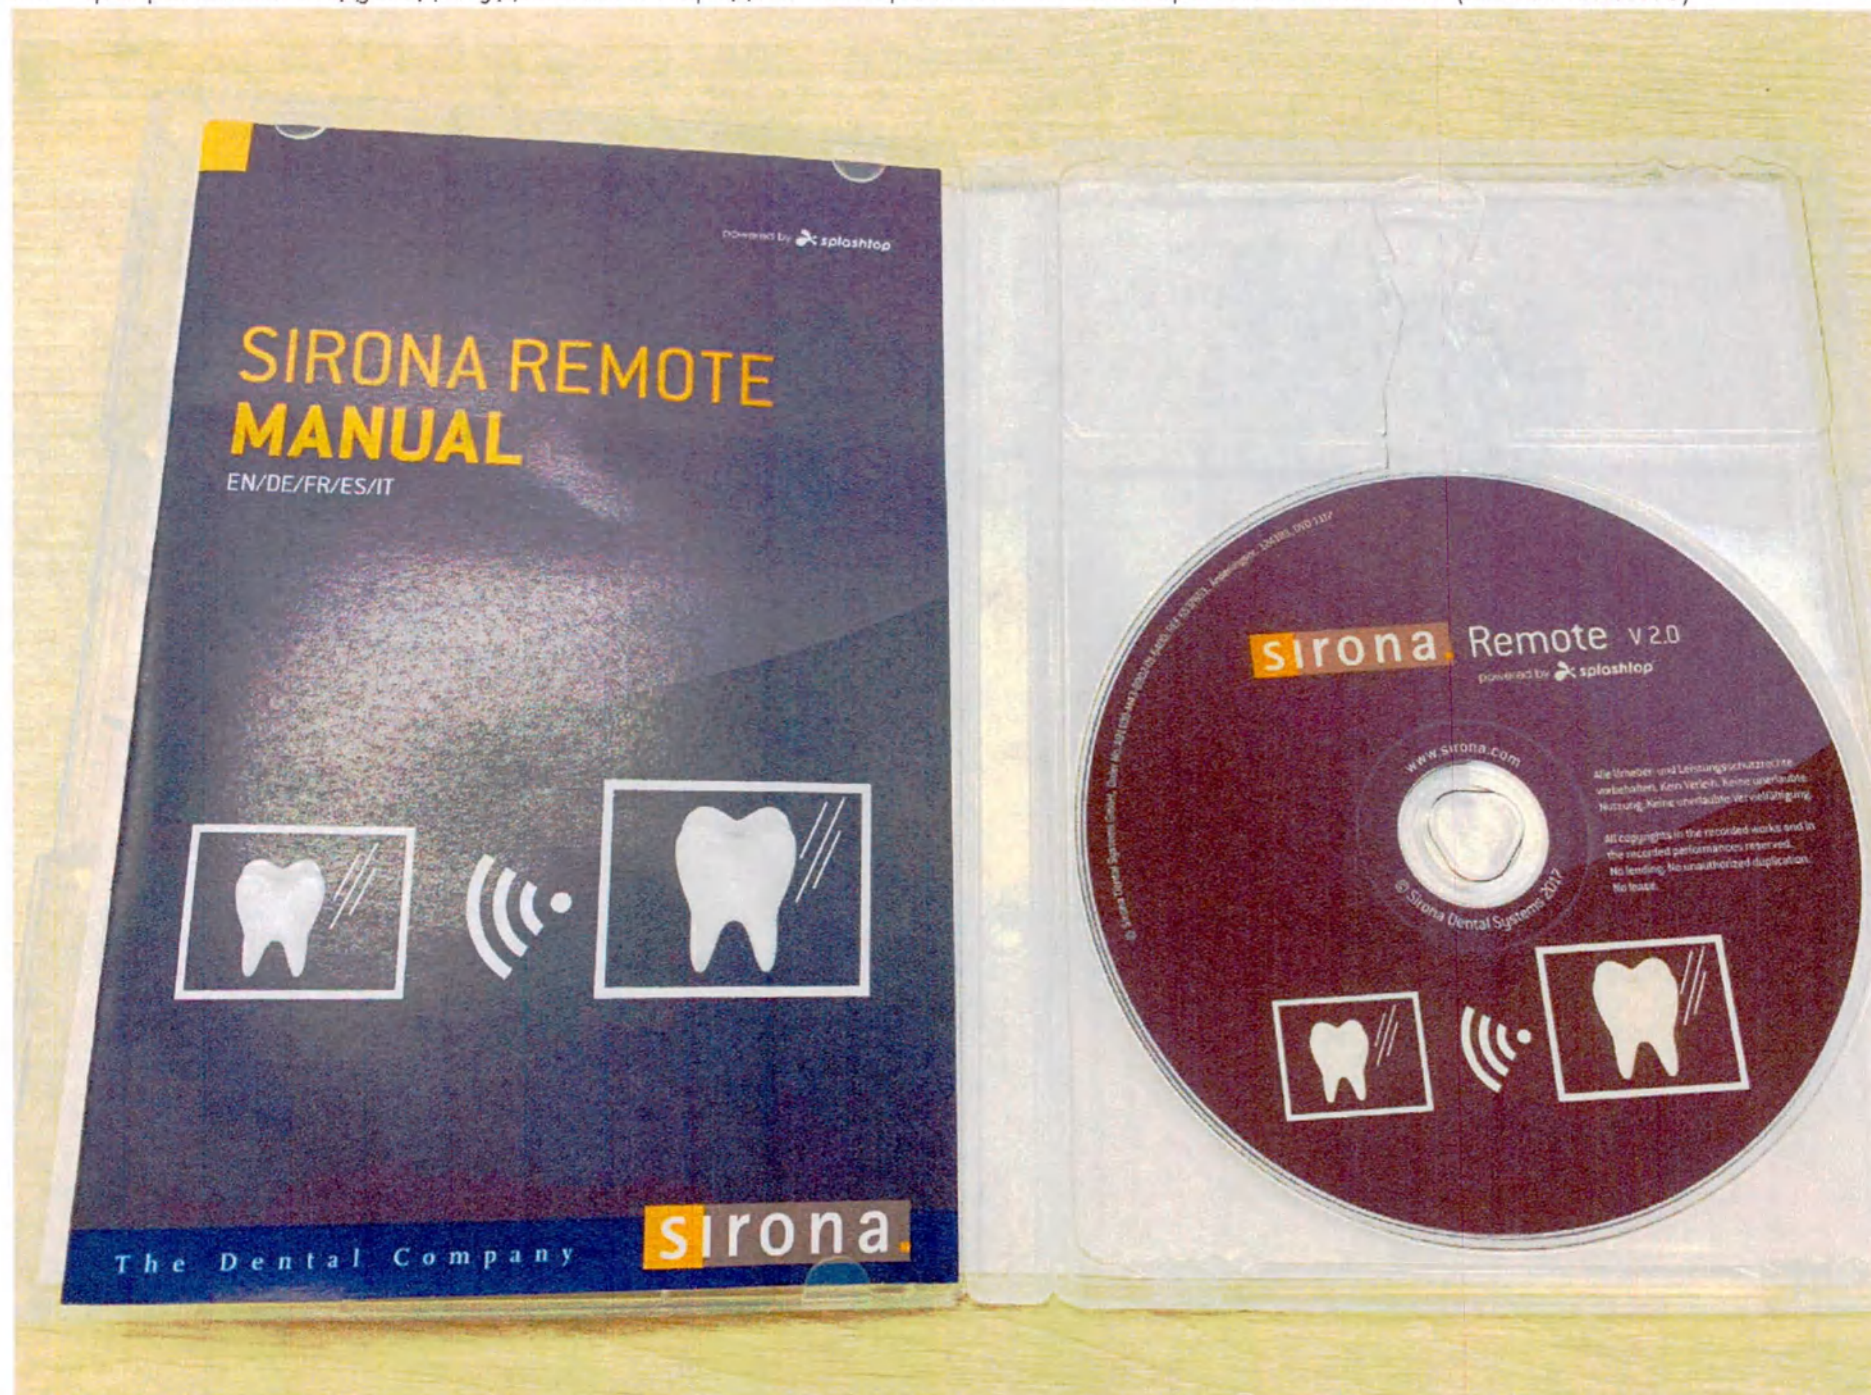





VII. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan Connect:




1. Камера внутриротовая Primescan.

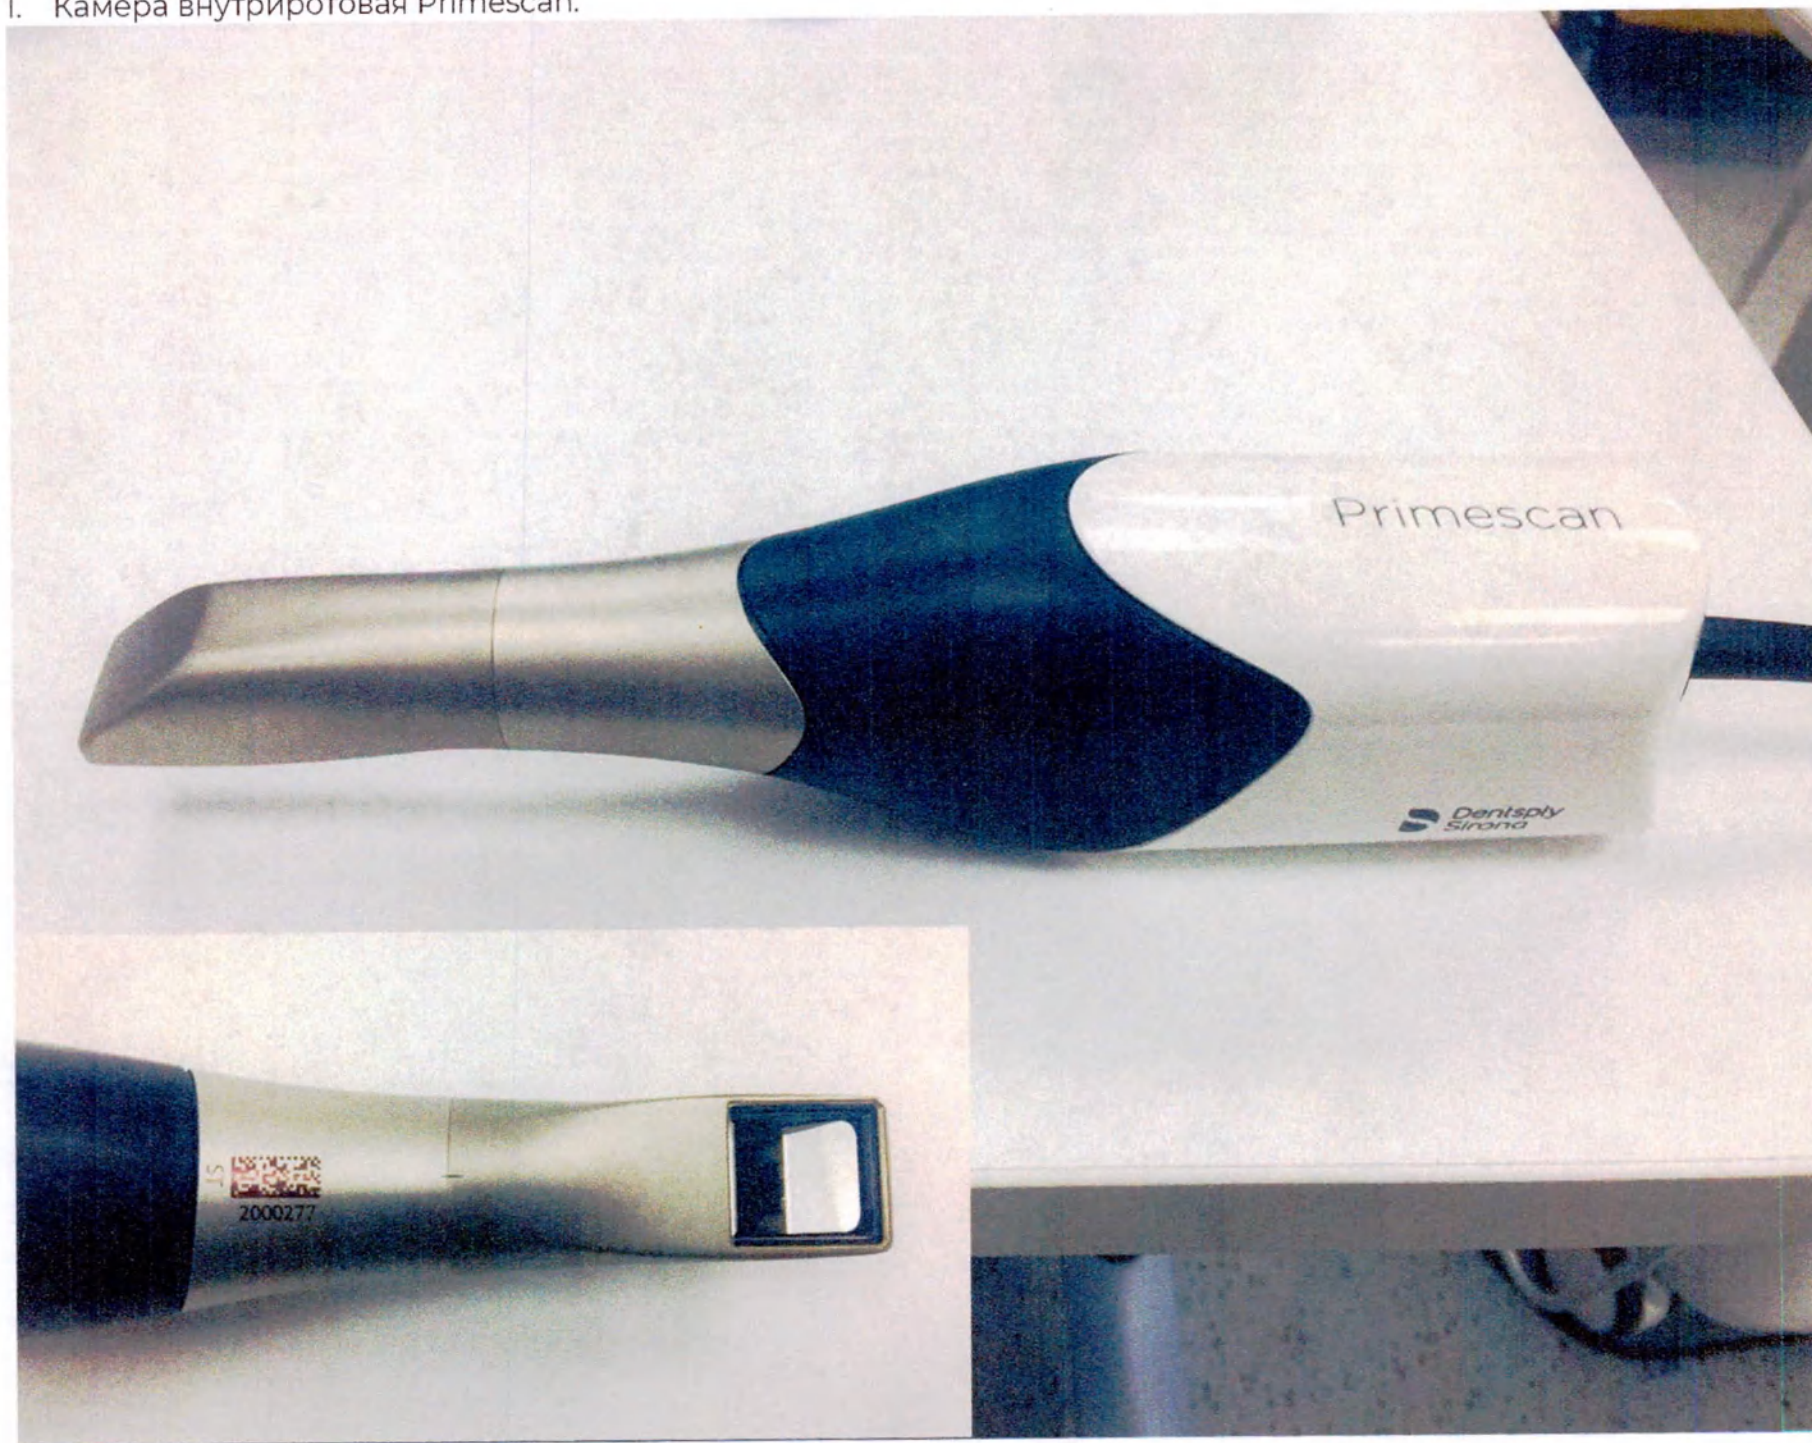

2. Держатель камеры.

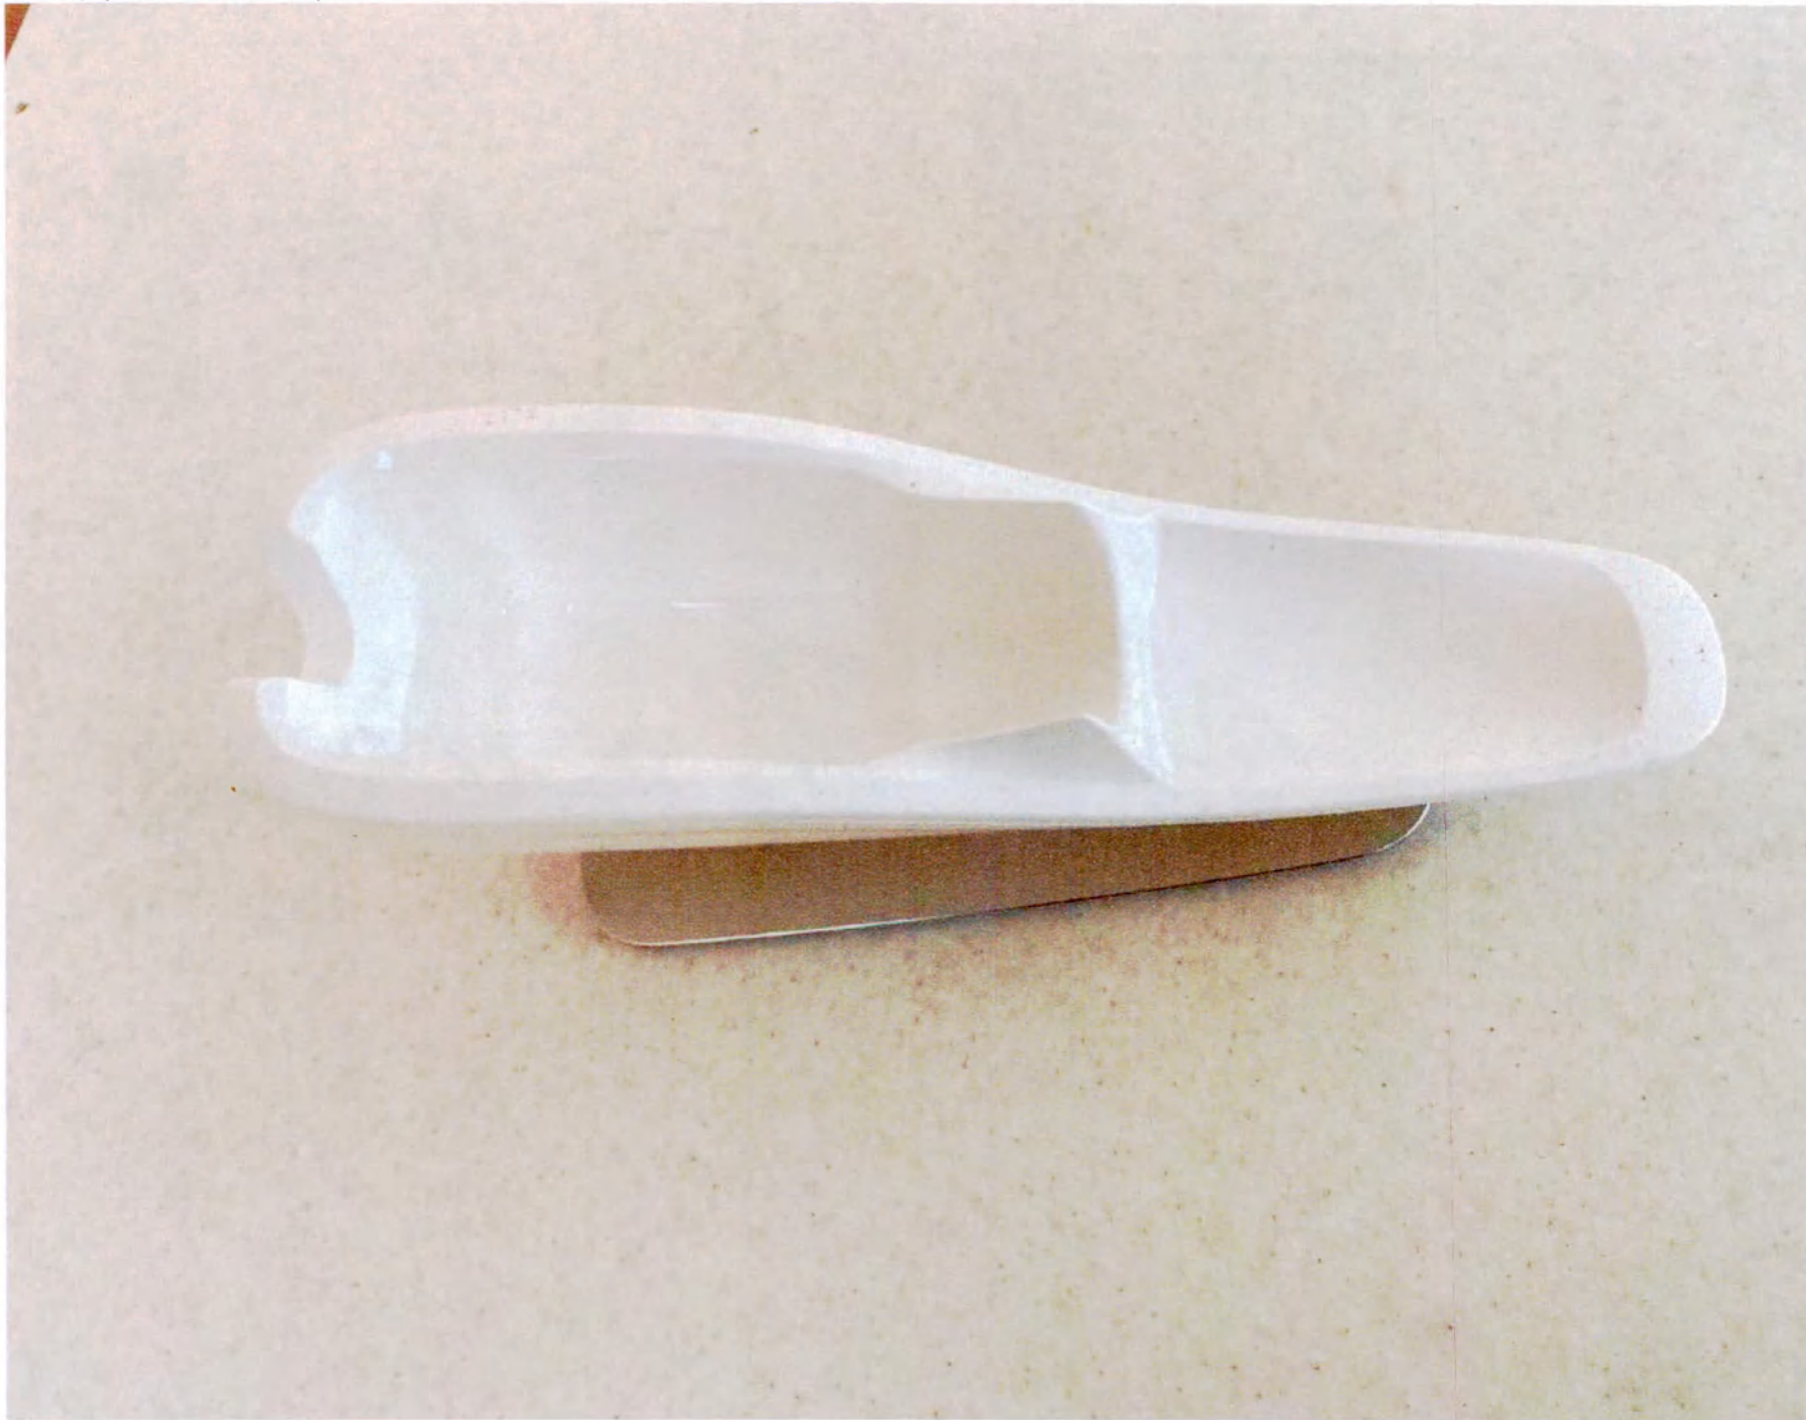

3. Соединительная коробка.

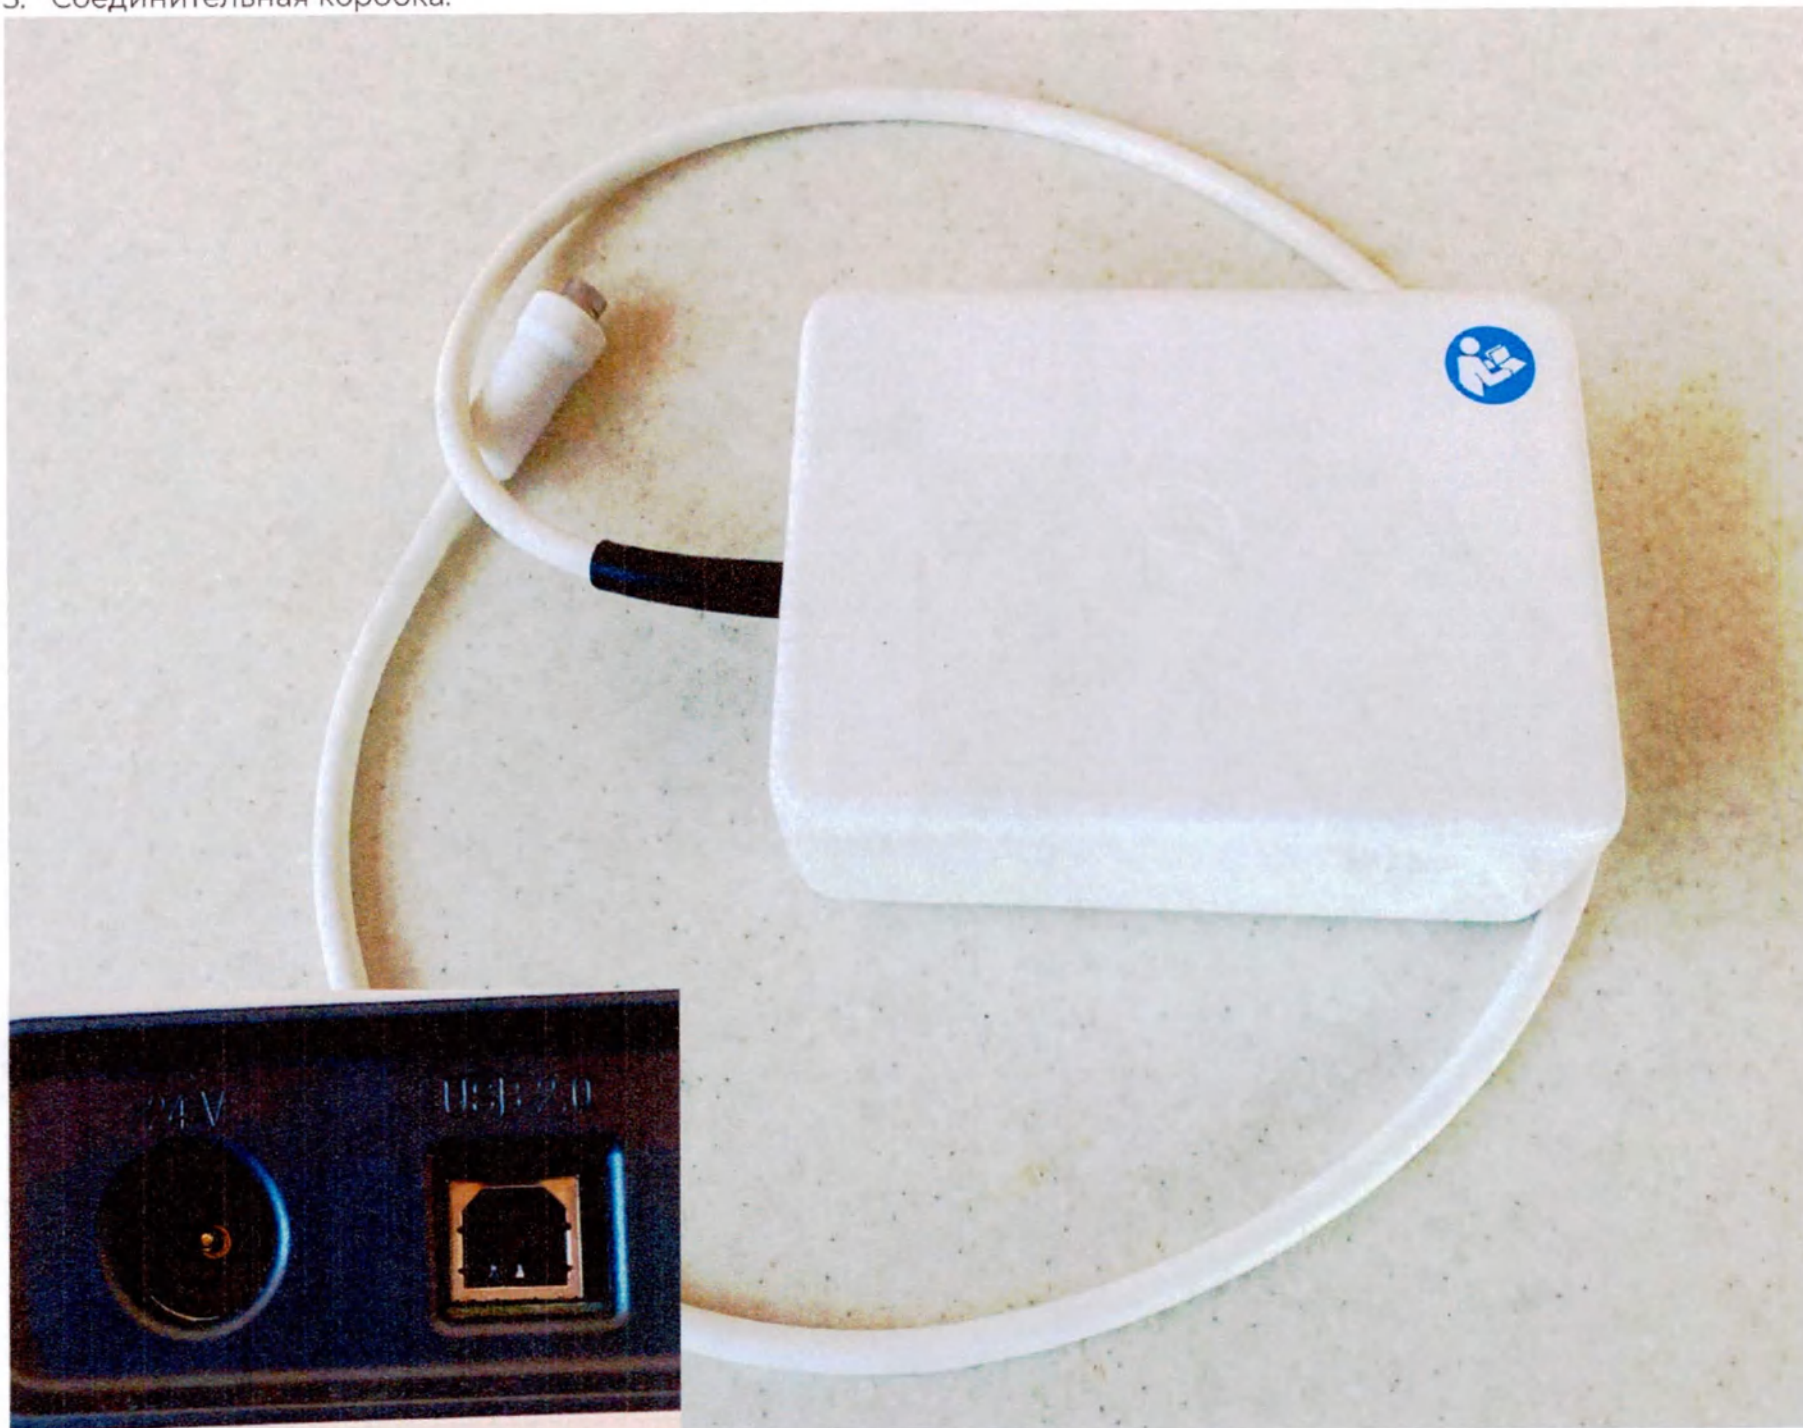

4. Насадка калибровочная для настройки точности.




5. Насадка калибровочная для настройки цвета.



6. Наконечник металлический для камеры Primescan.




7. Наконечник одноразовый для камеры Primescan.

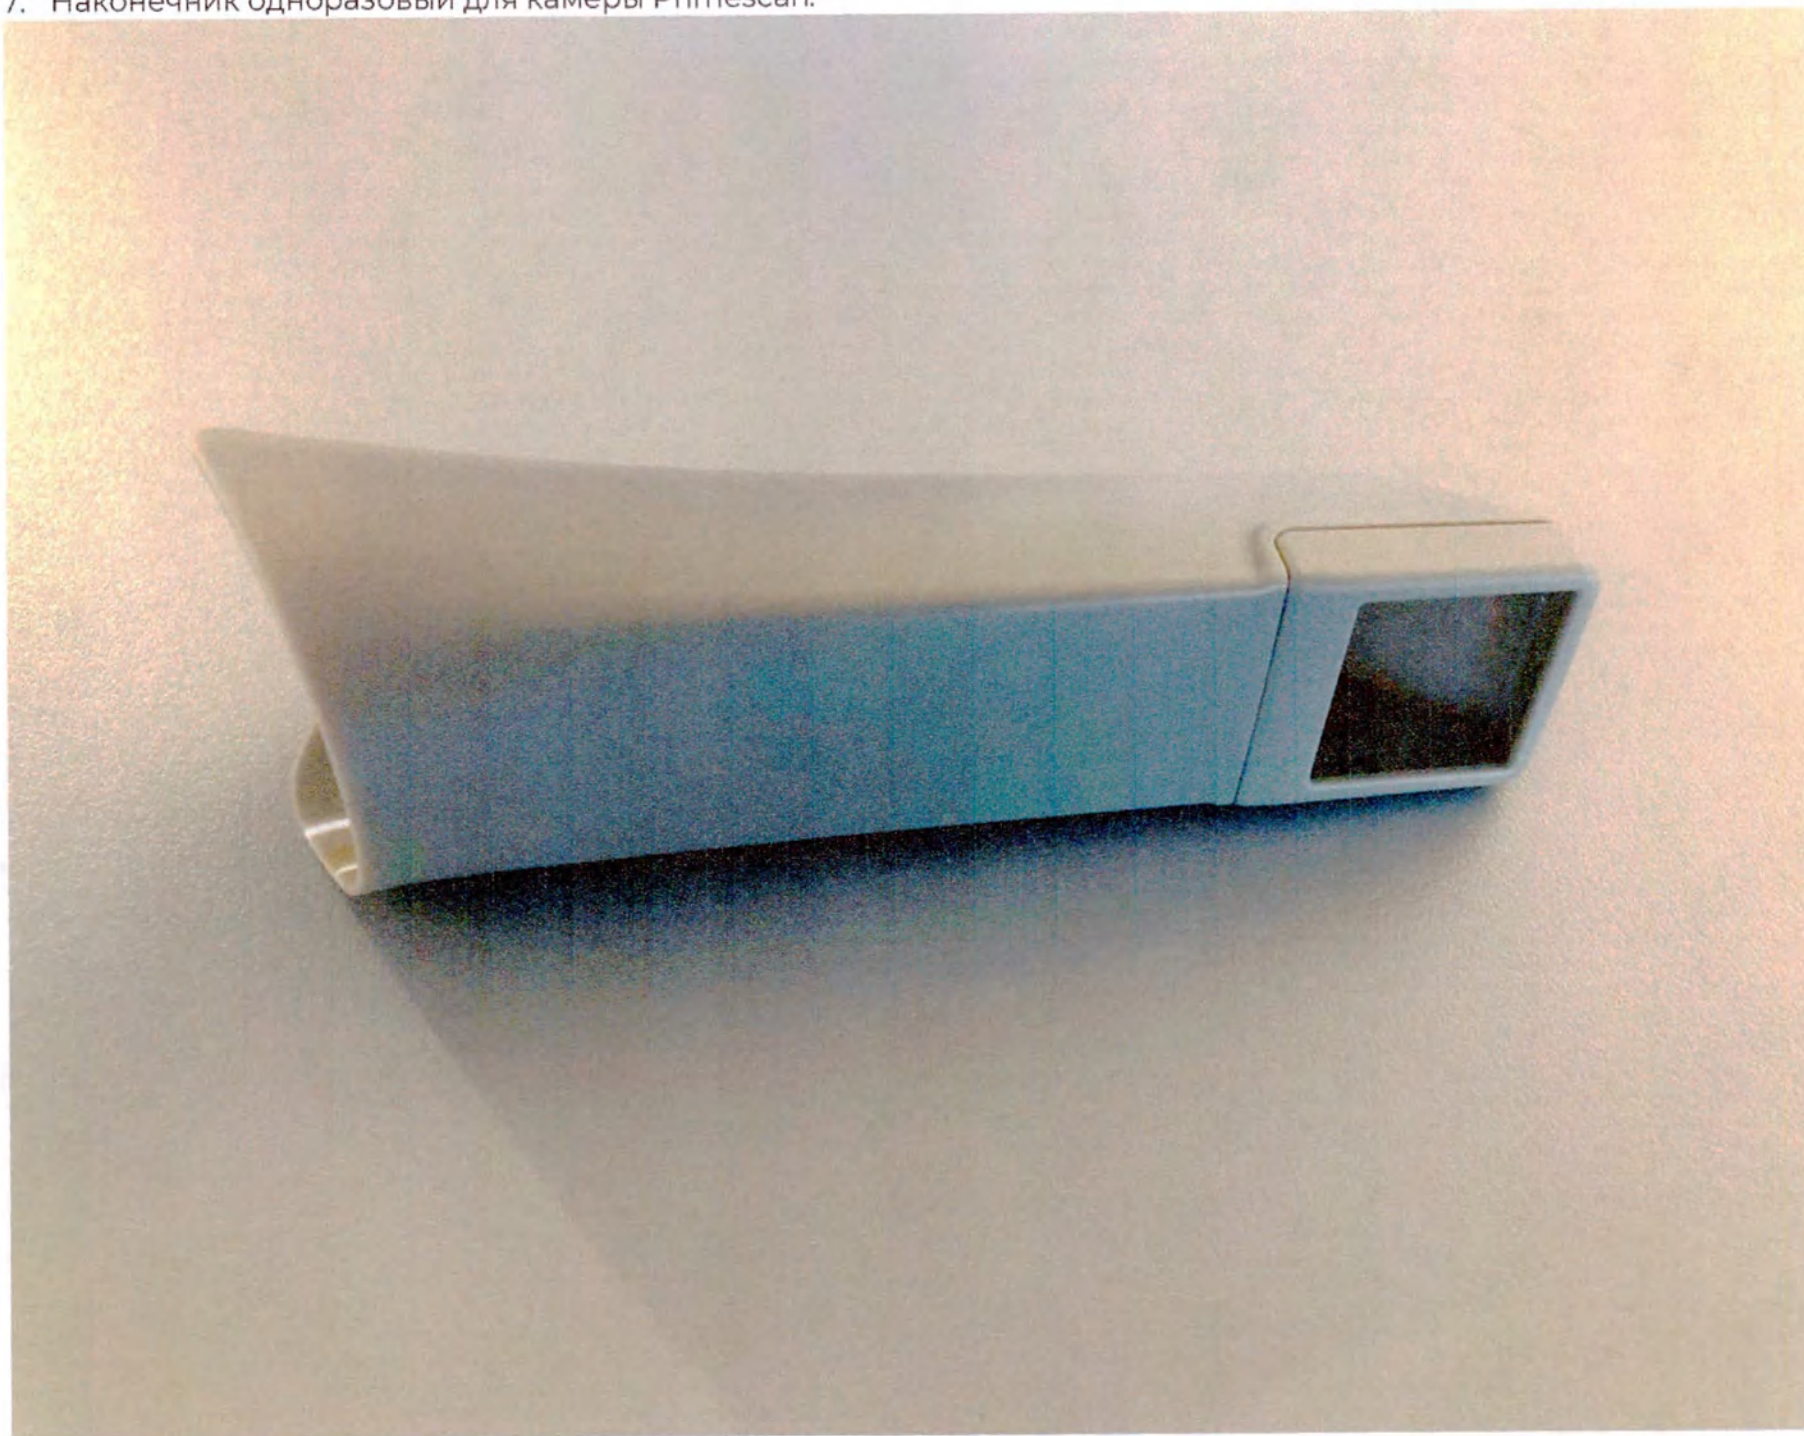

8. Заглушка пластиковая для камеры.




9. Уплотнительные кольца O-rings.

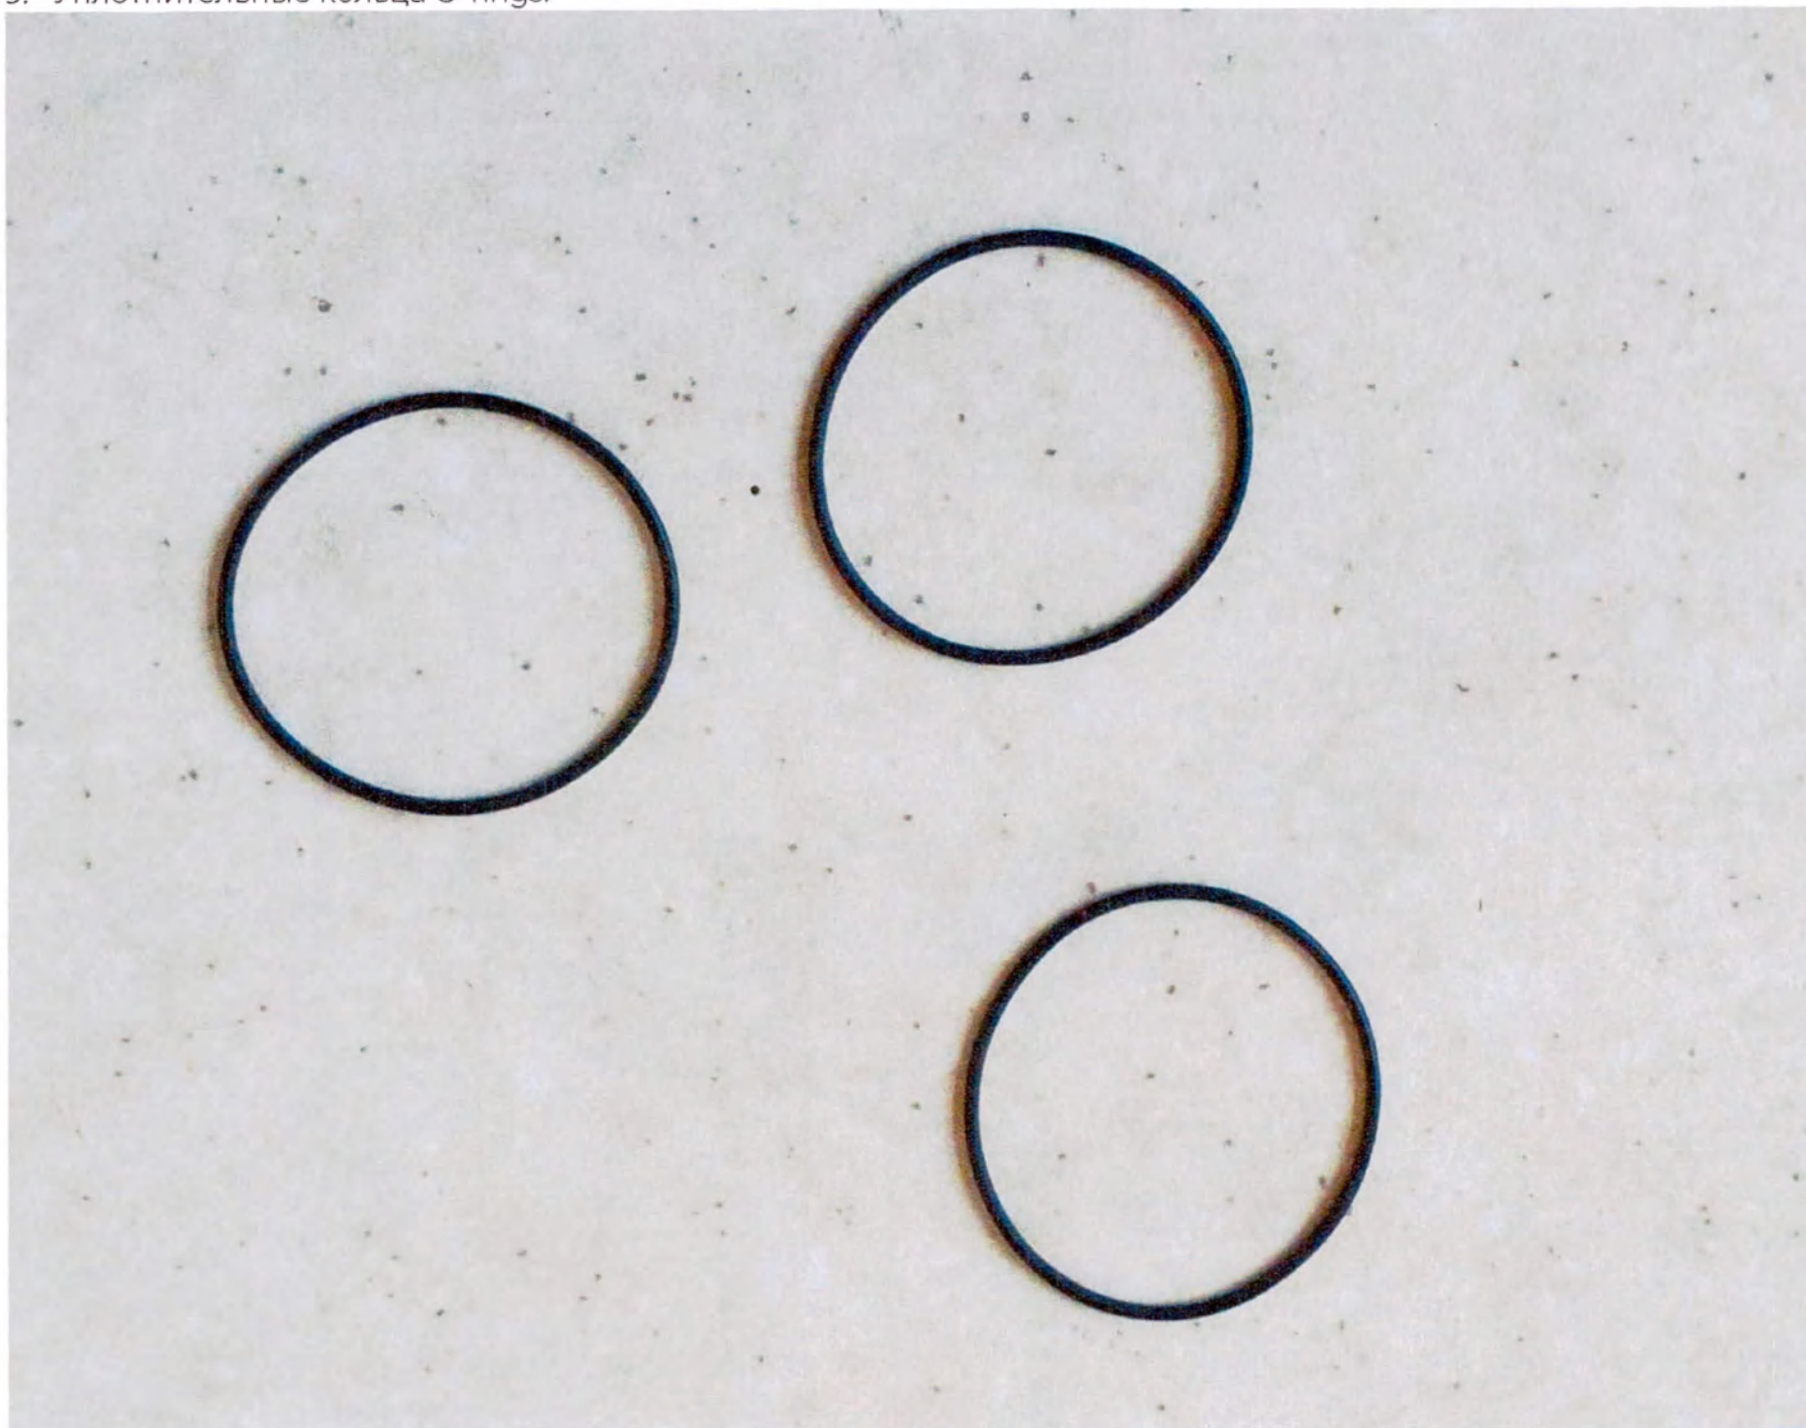


10. Кабель USB.



11. Оригинальный кейс для хранения камеры внутриротовой Primescan.

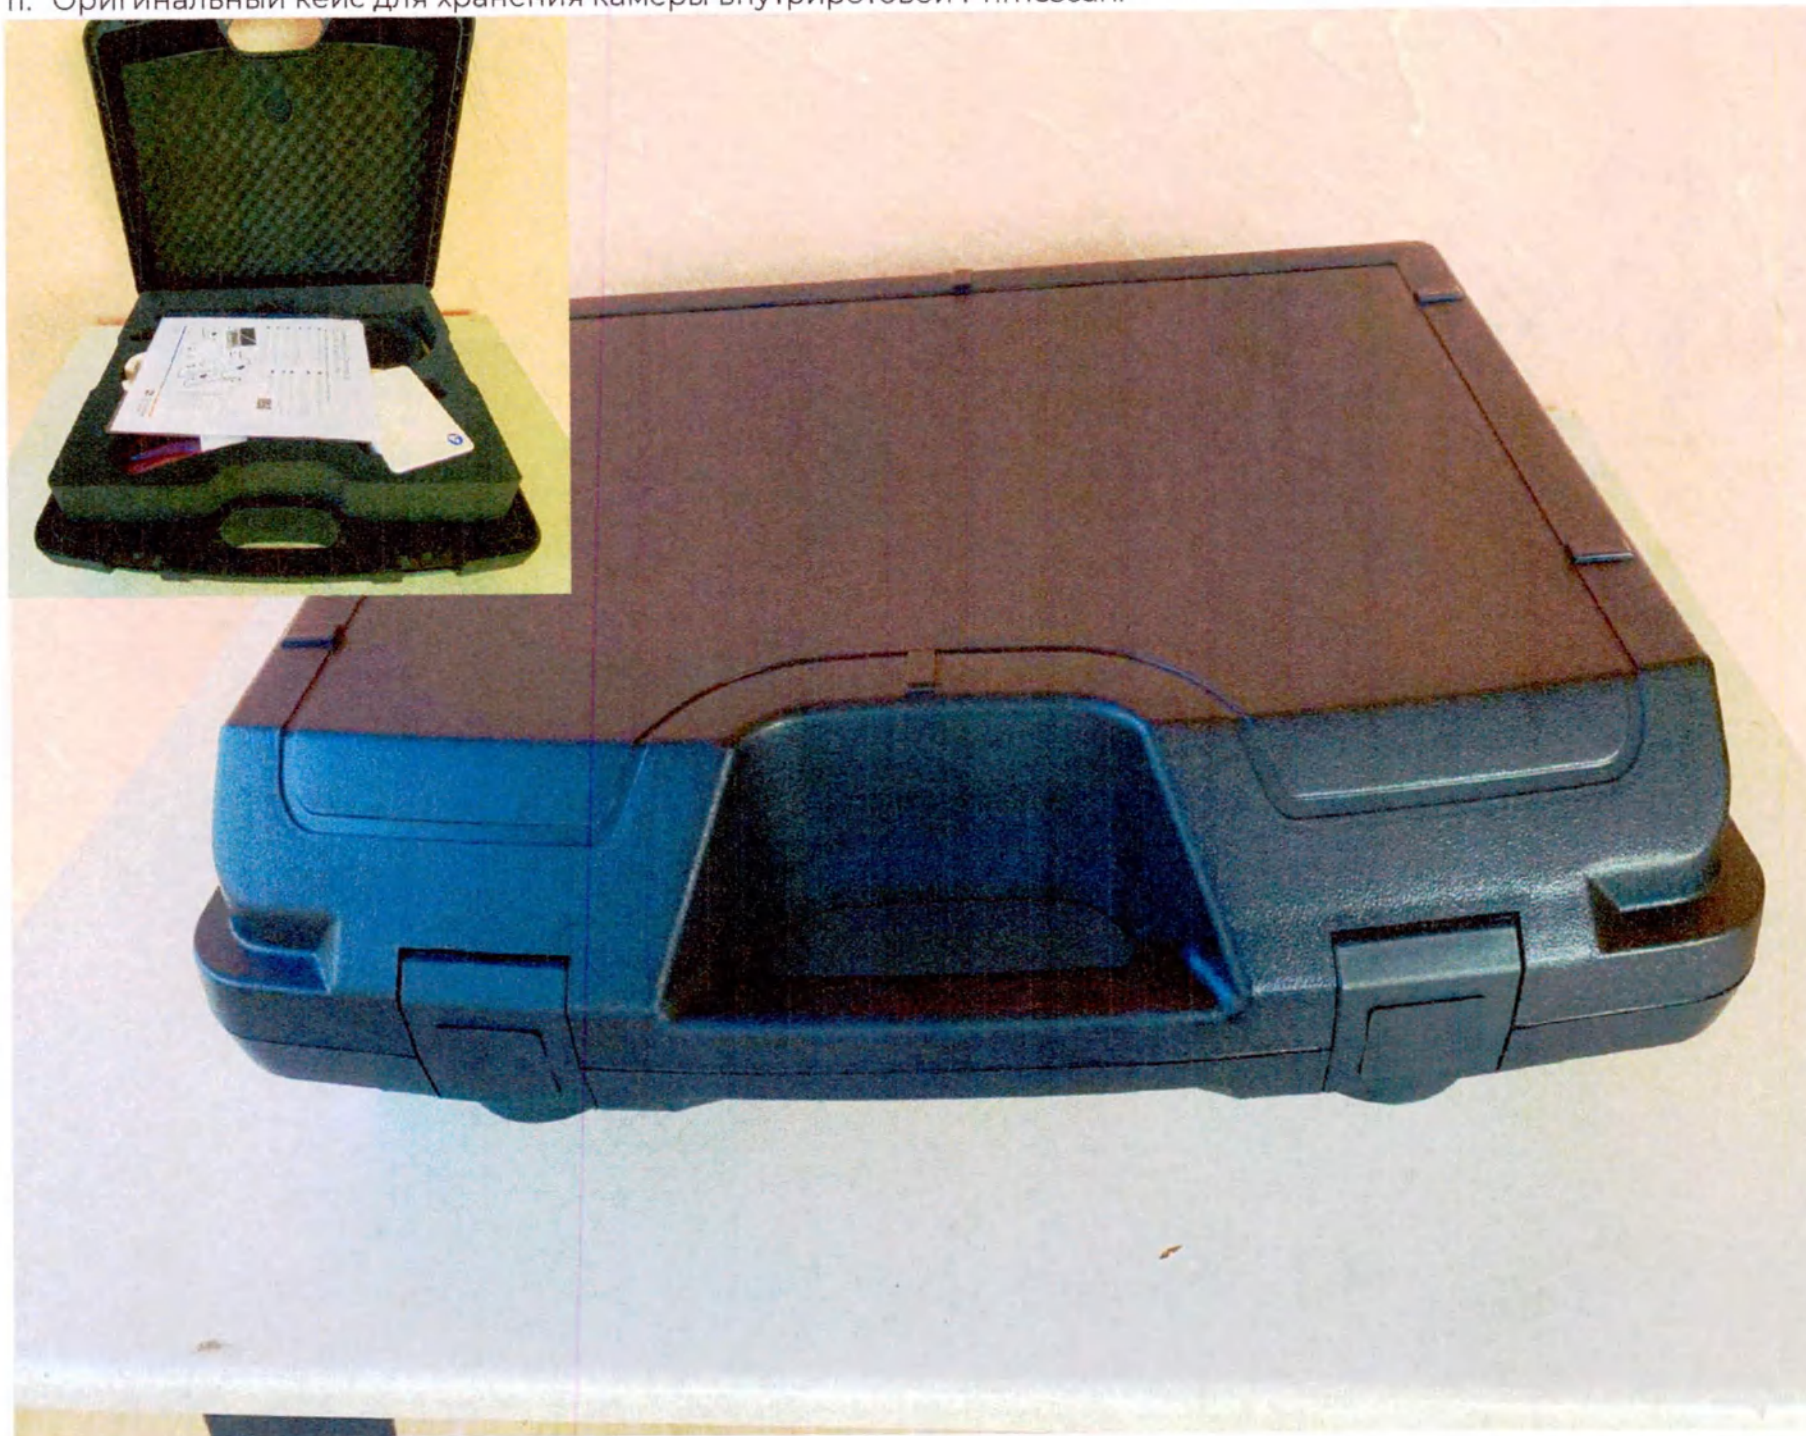


12. USB носитель с программными лицензиями.

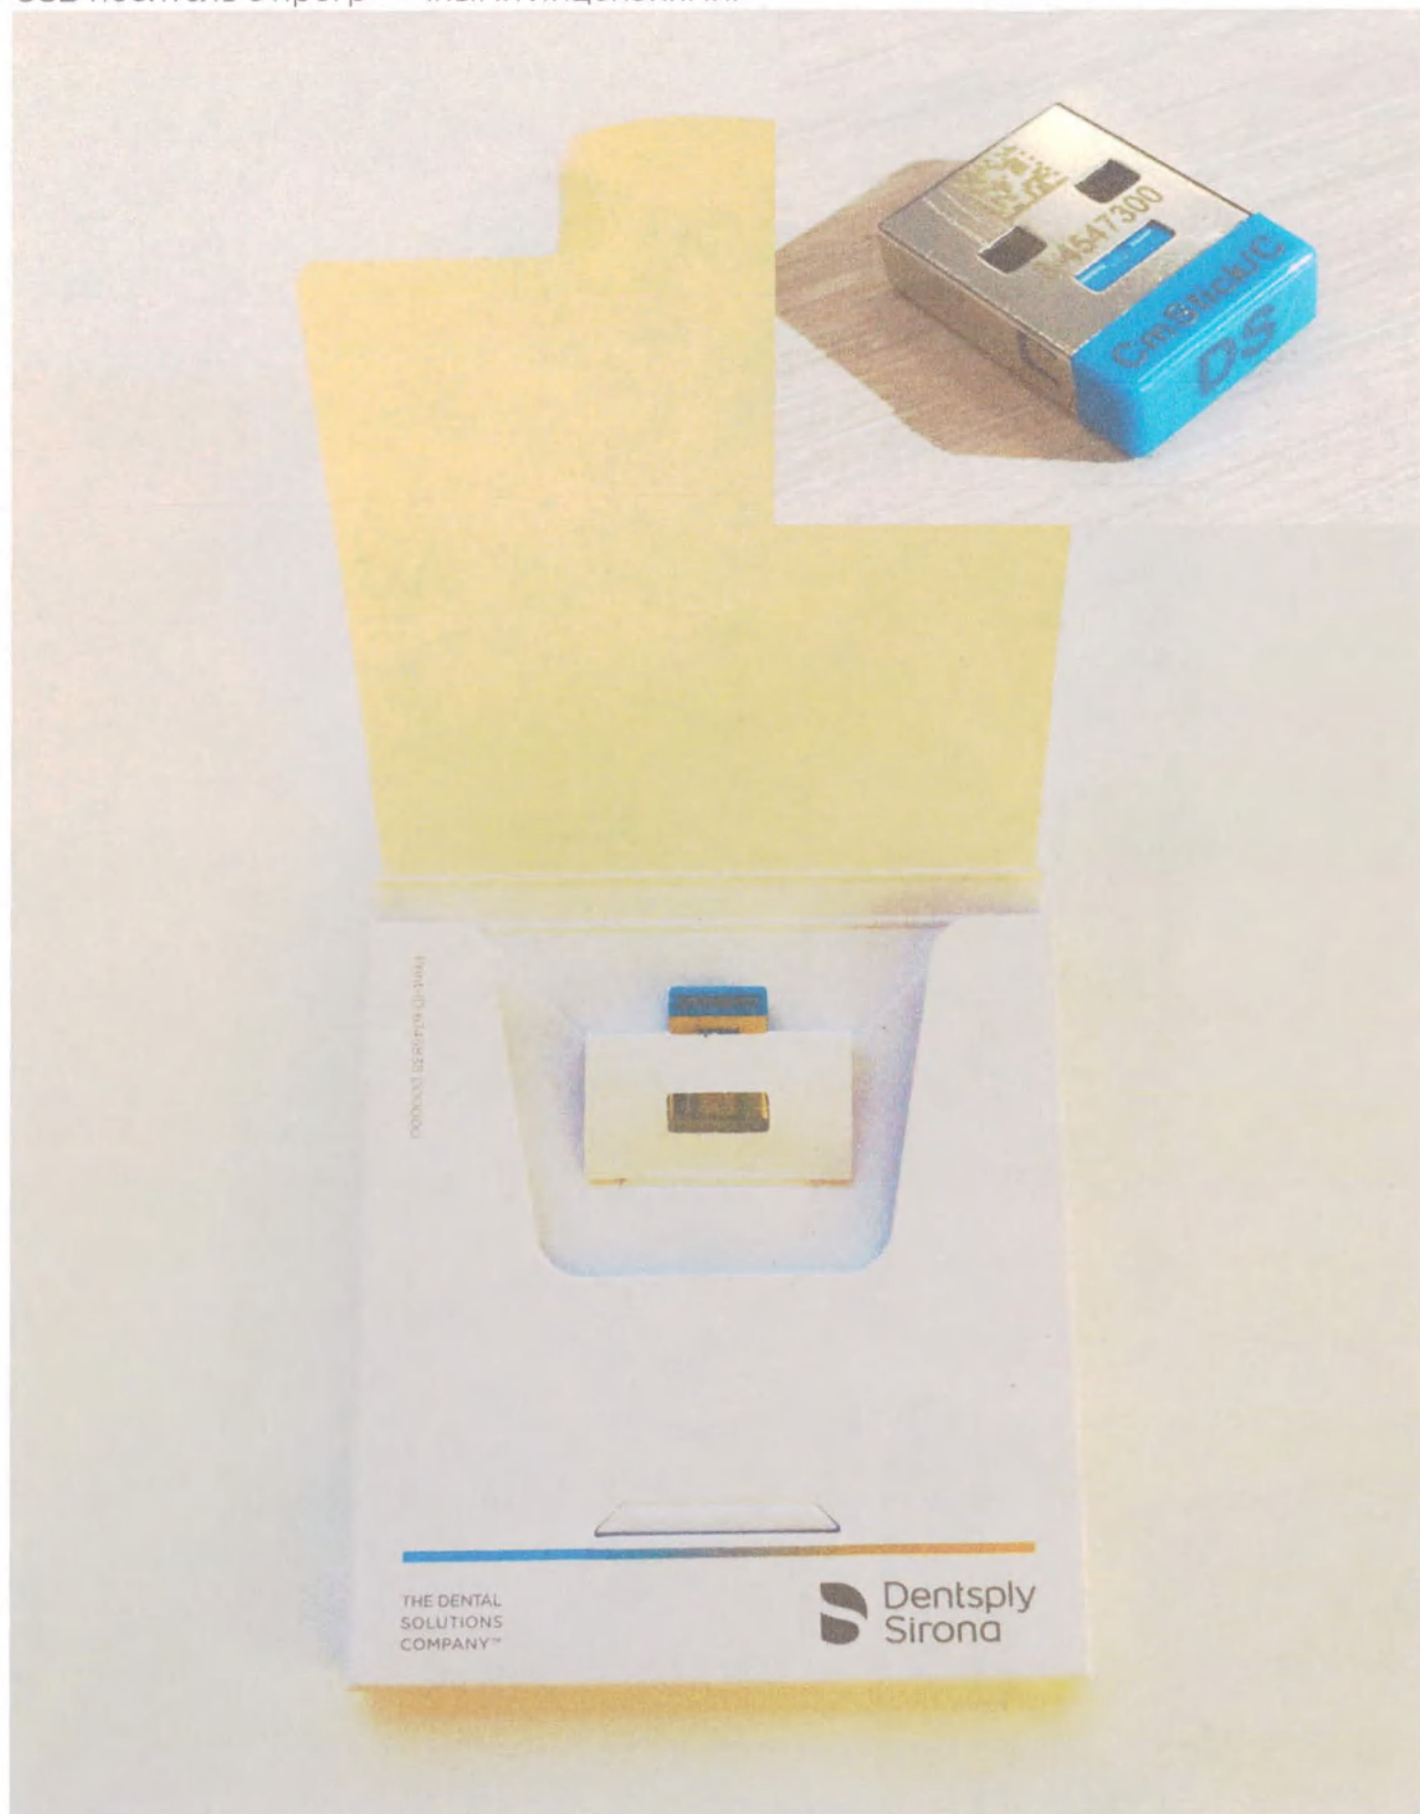



14. Кабель сетевой медицинской блока питания соединительной коробки.

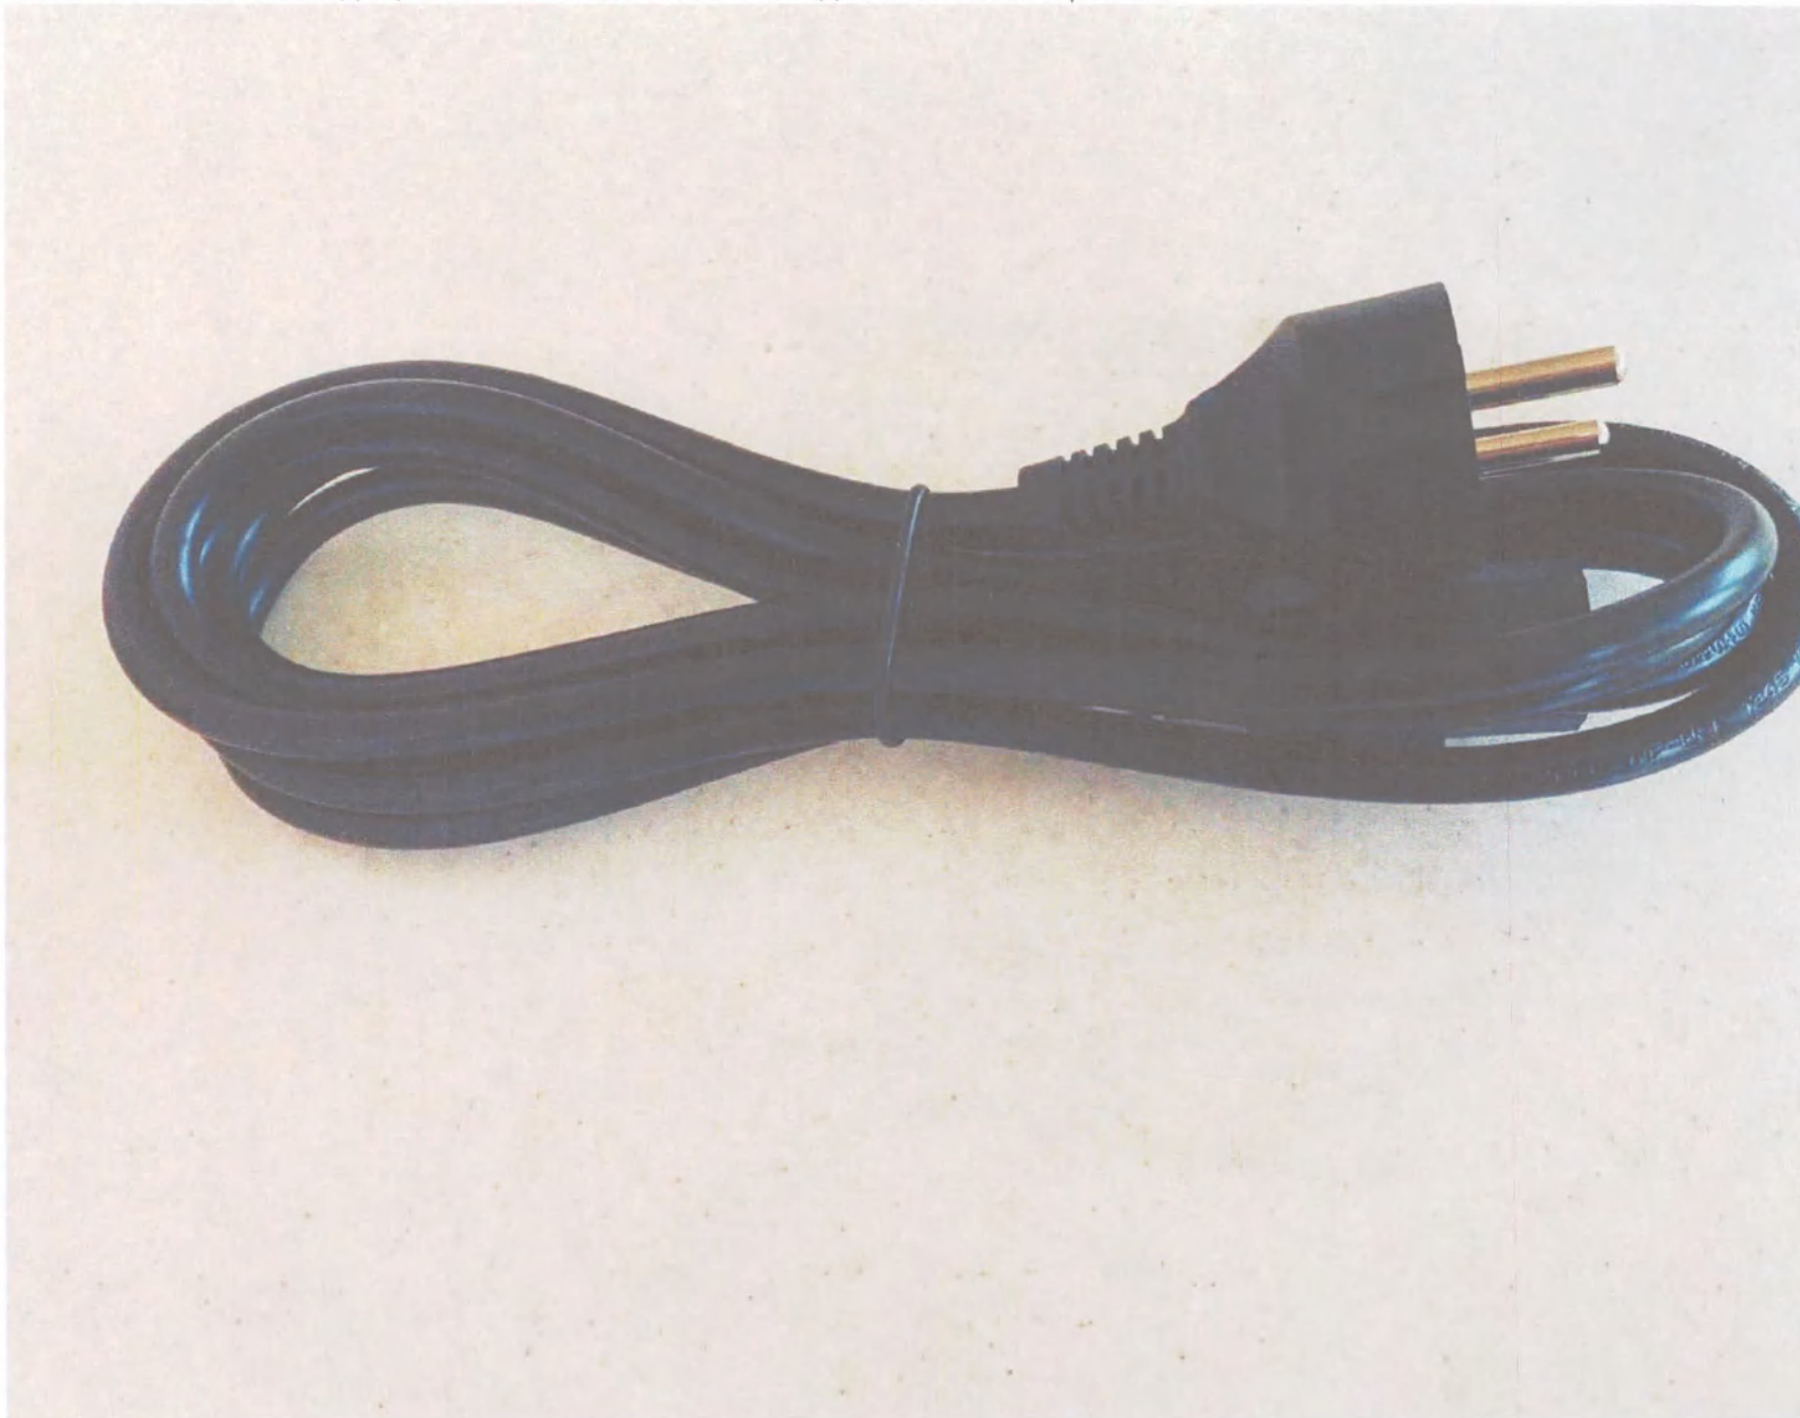


Кабель сетевой модели BXP-PC-186-VDE-3M, производства «Pogo Technology International Limited», Китай медицинского блока питания соединительной коробки.




15. Ноутбук.



16. Медицинский блок питания ноутбука.

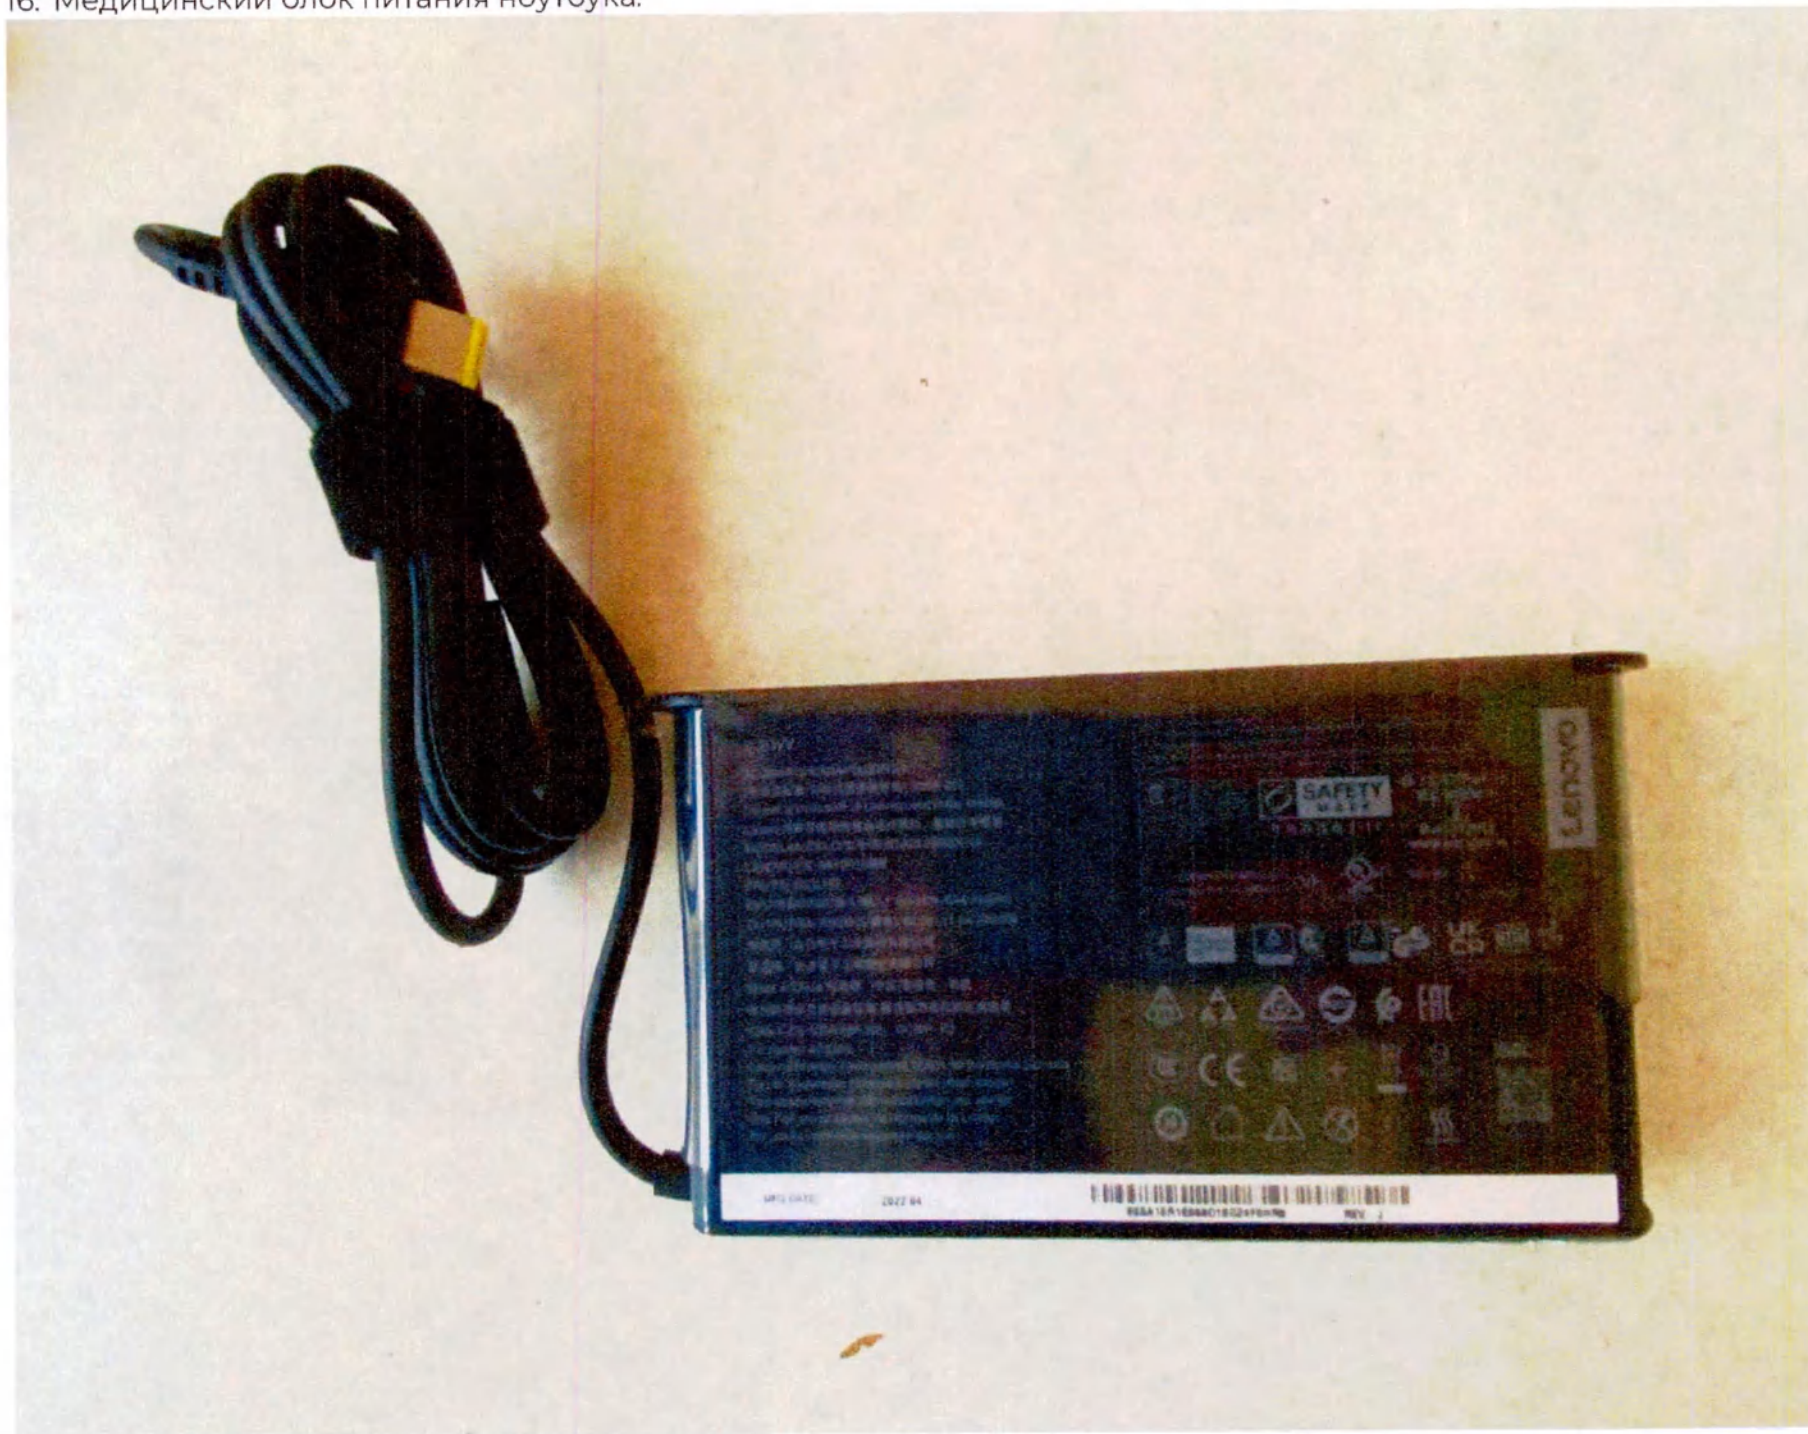


17. Кабель сетевой медицинской блока питания ноутбука.

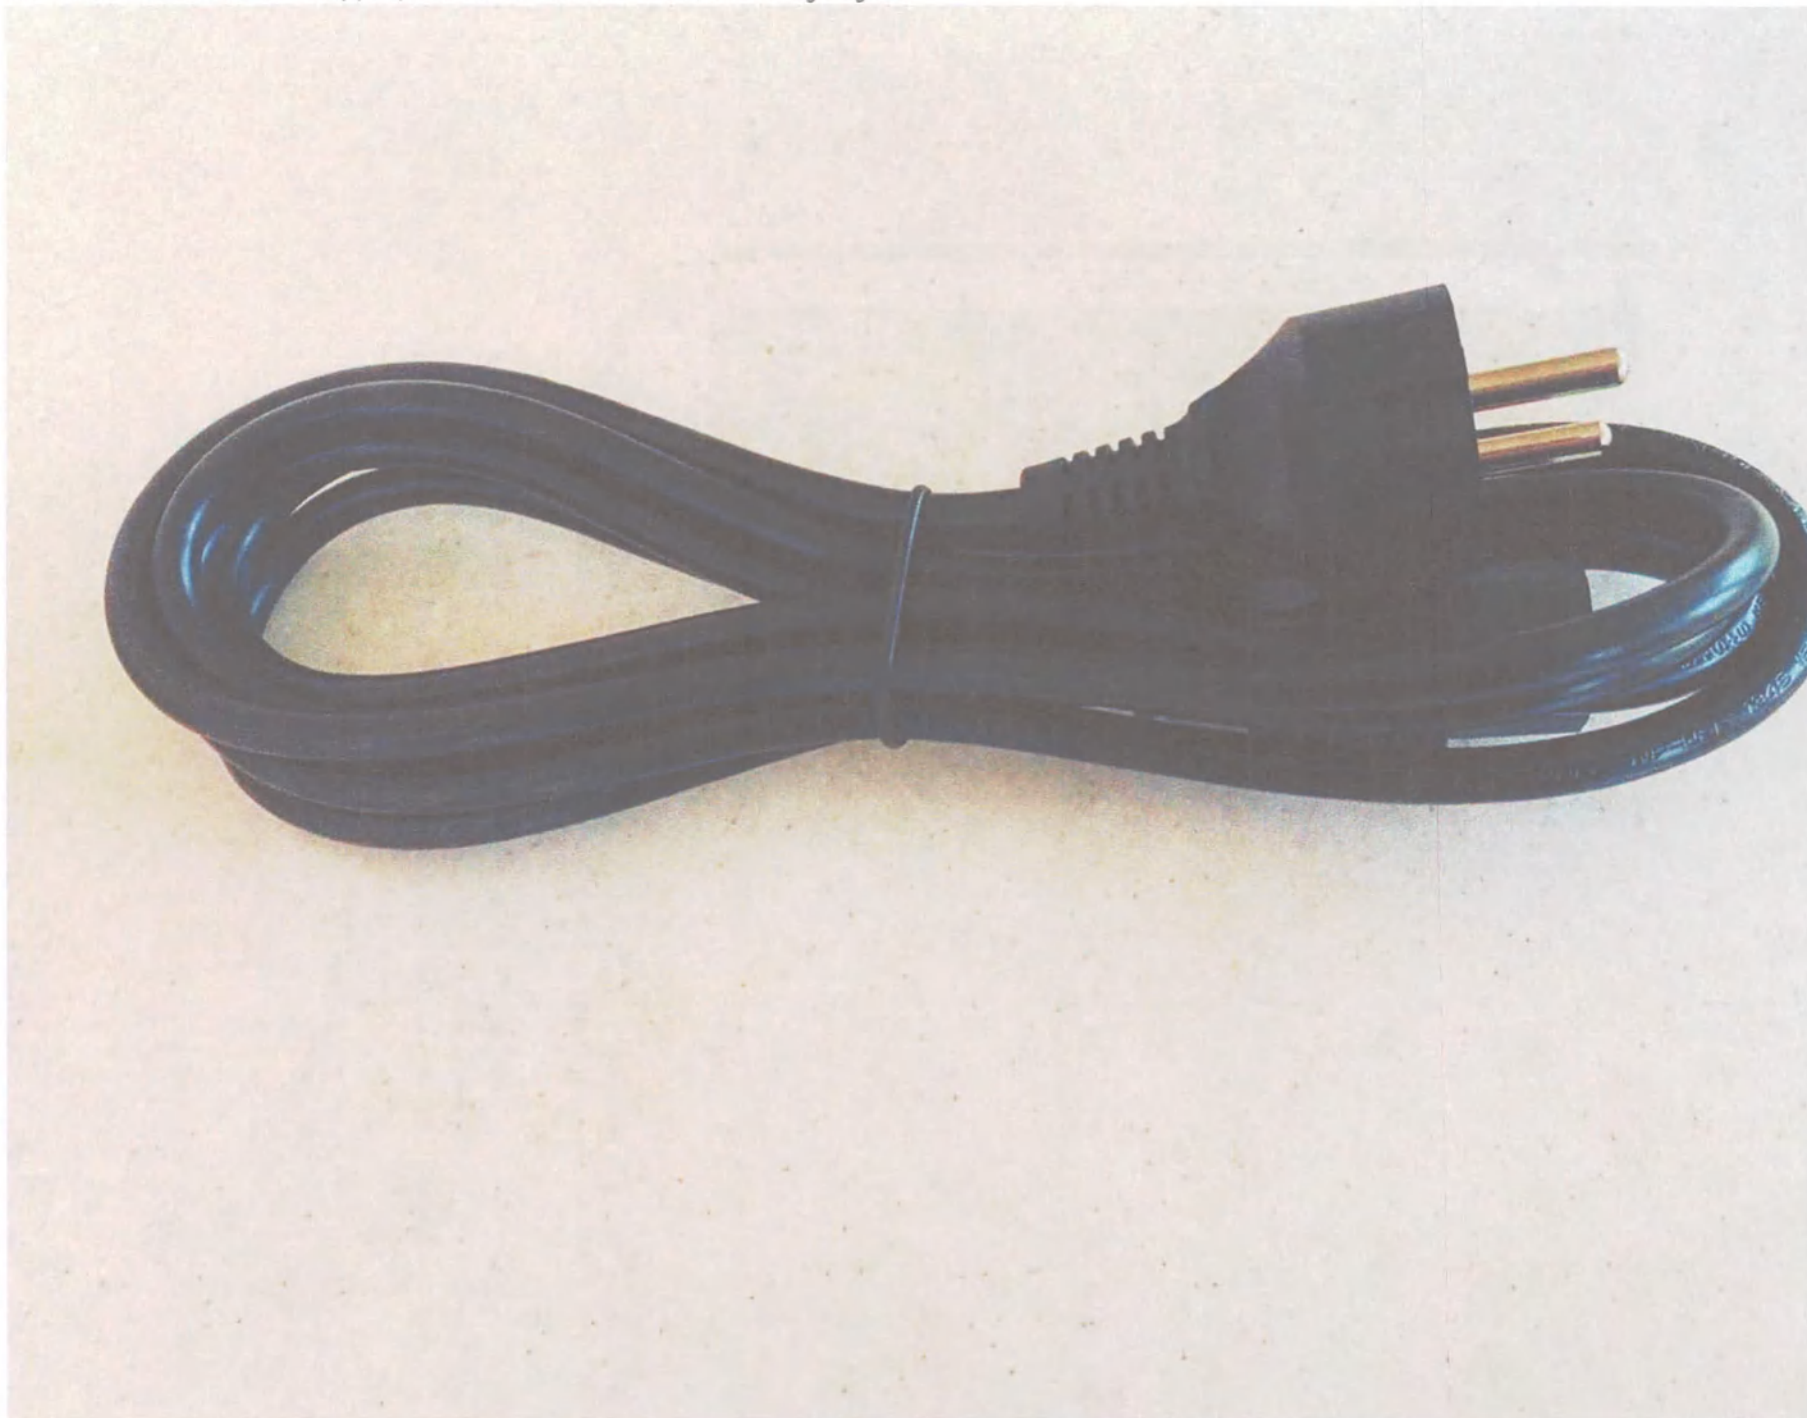






19. Программное обеспечение Connect SW в предустановленном виде или загружаемое с сервера.

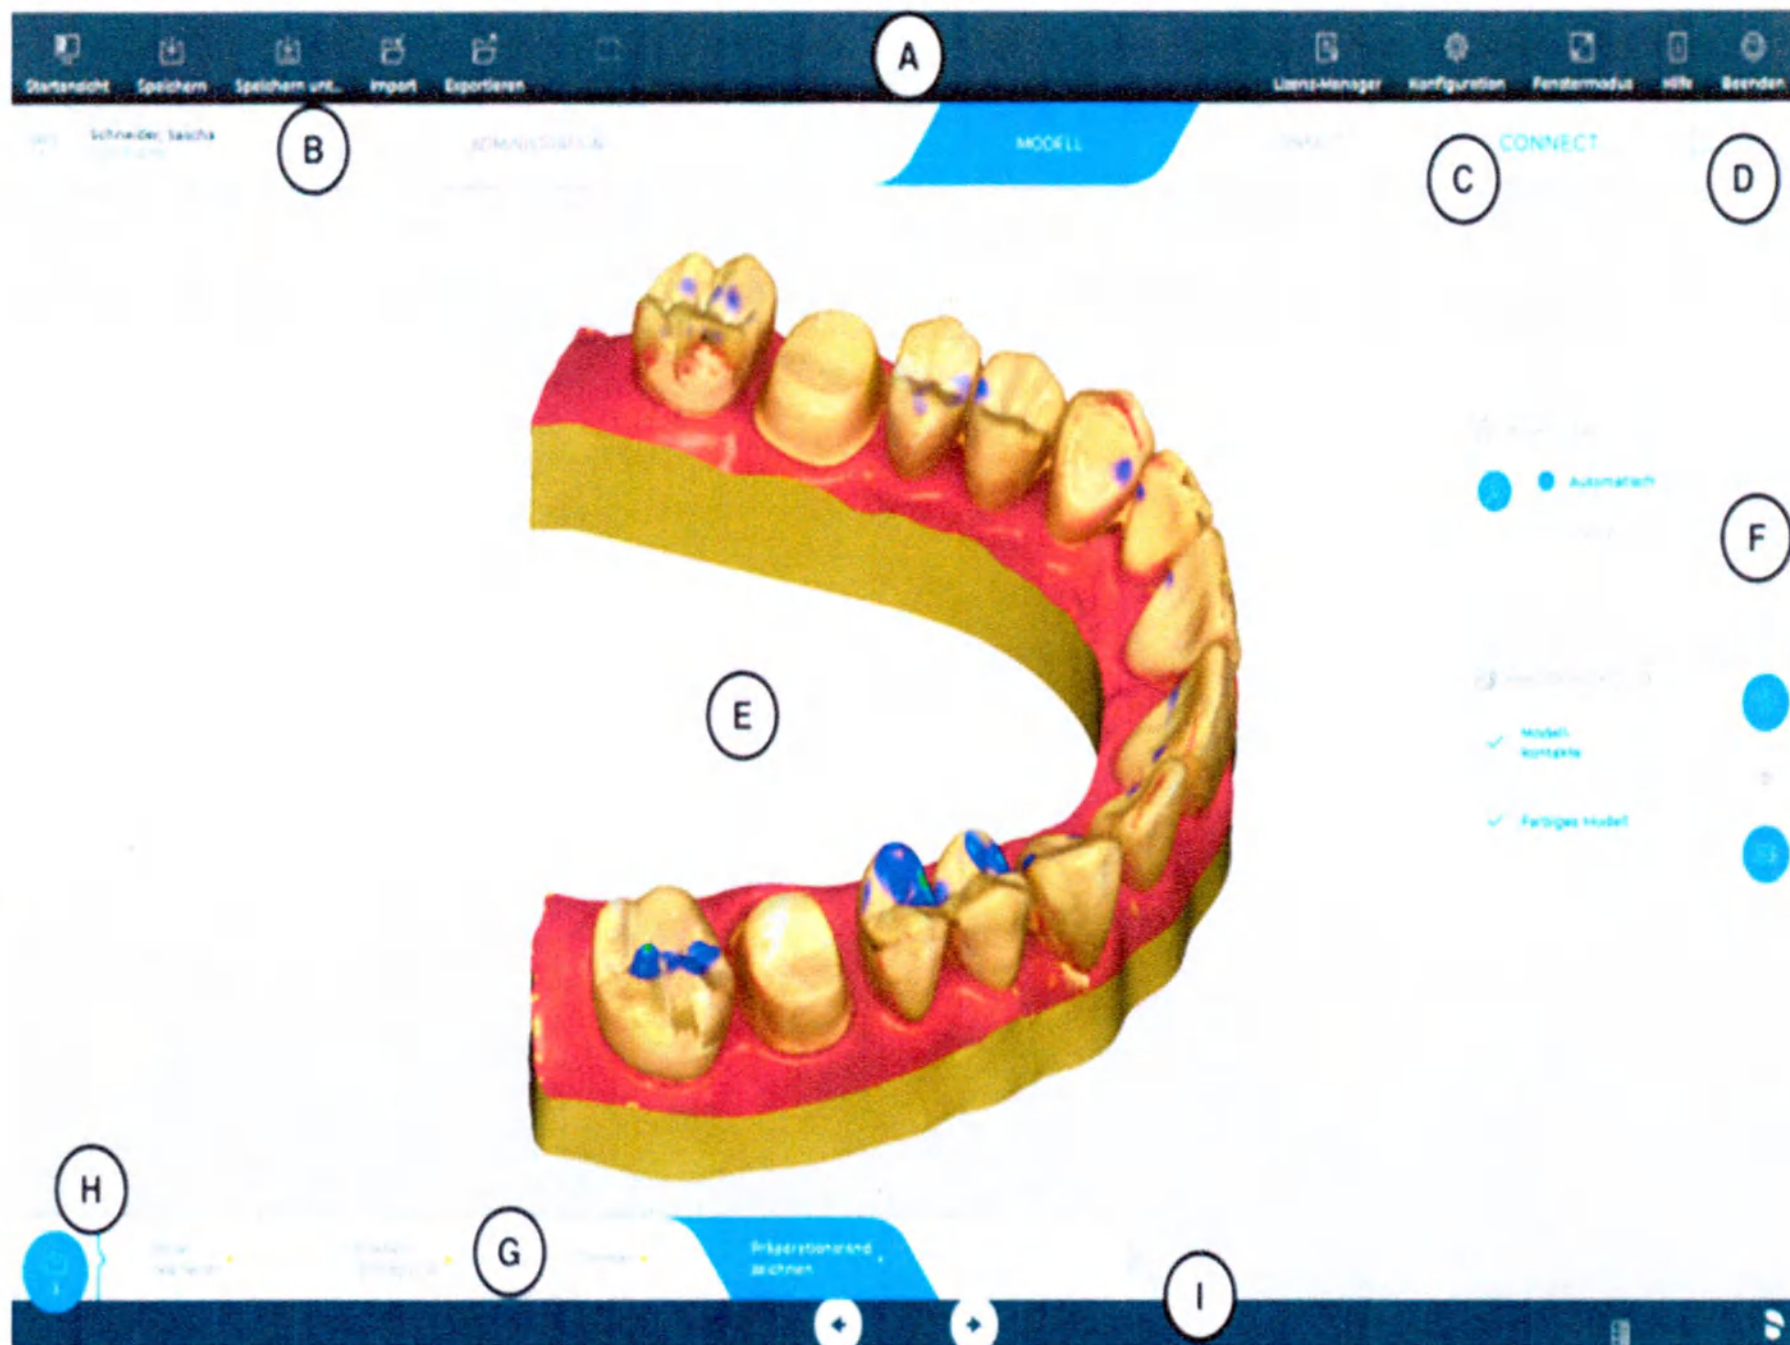



Обзор интерфейса

20. Программное обеспечение CEREC Ortho SW загружаемое с сервера или на электронном носителе.

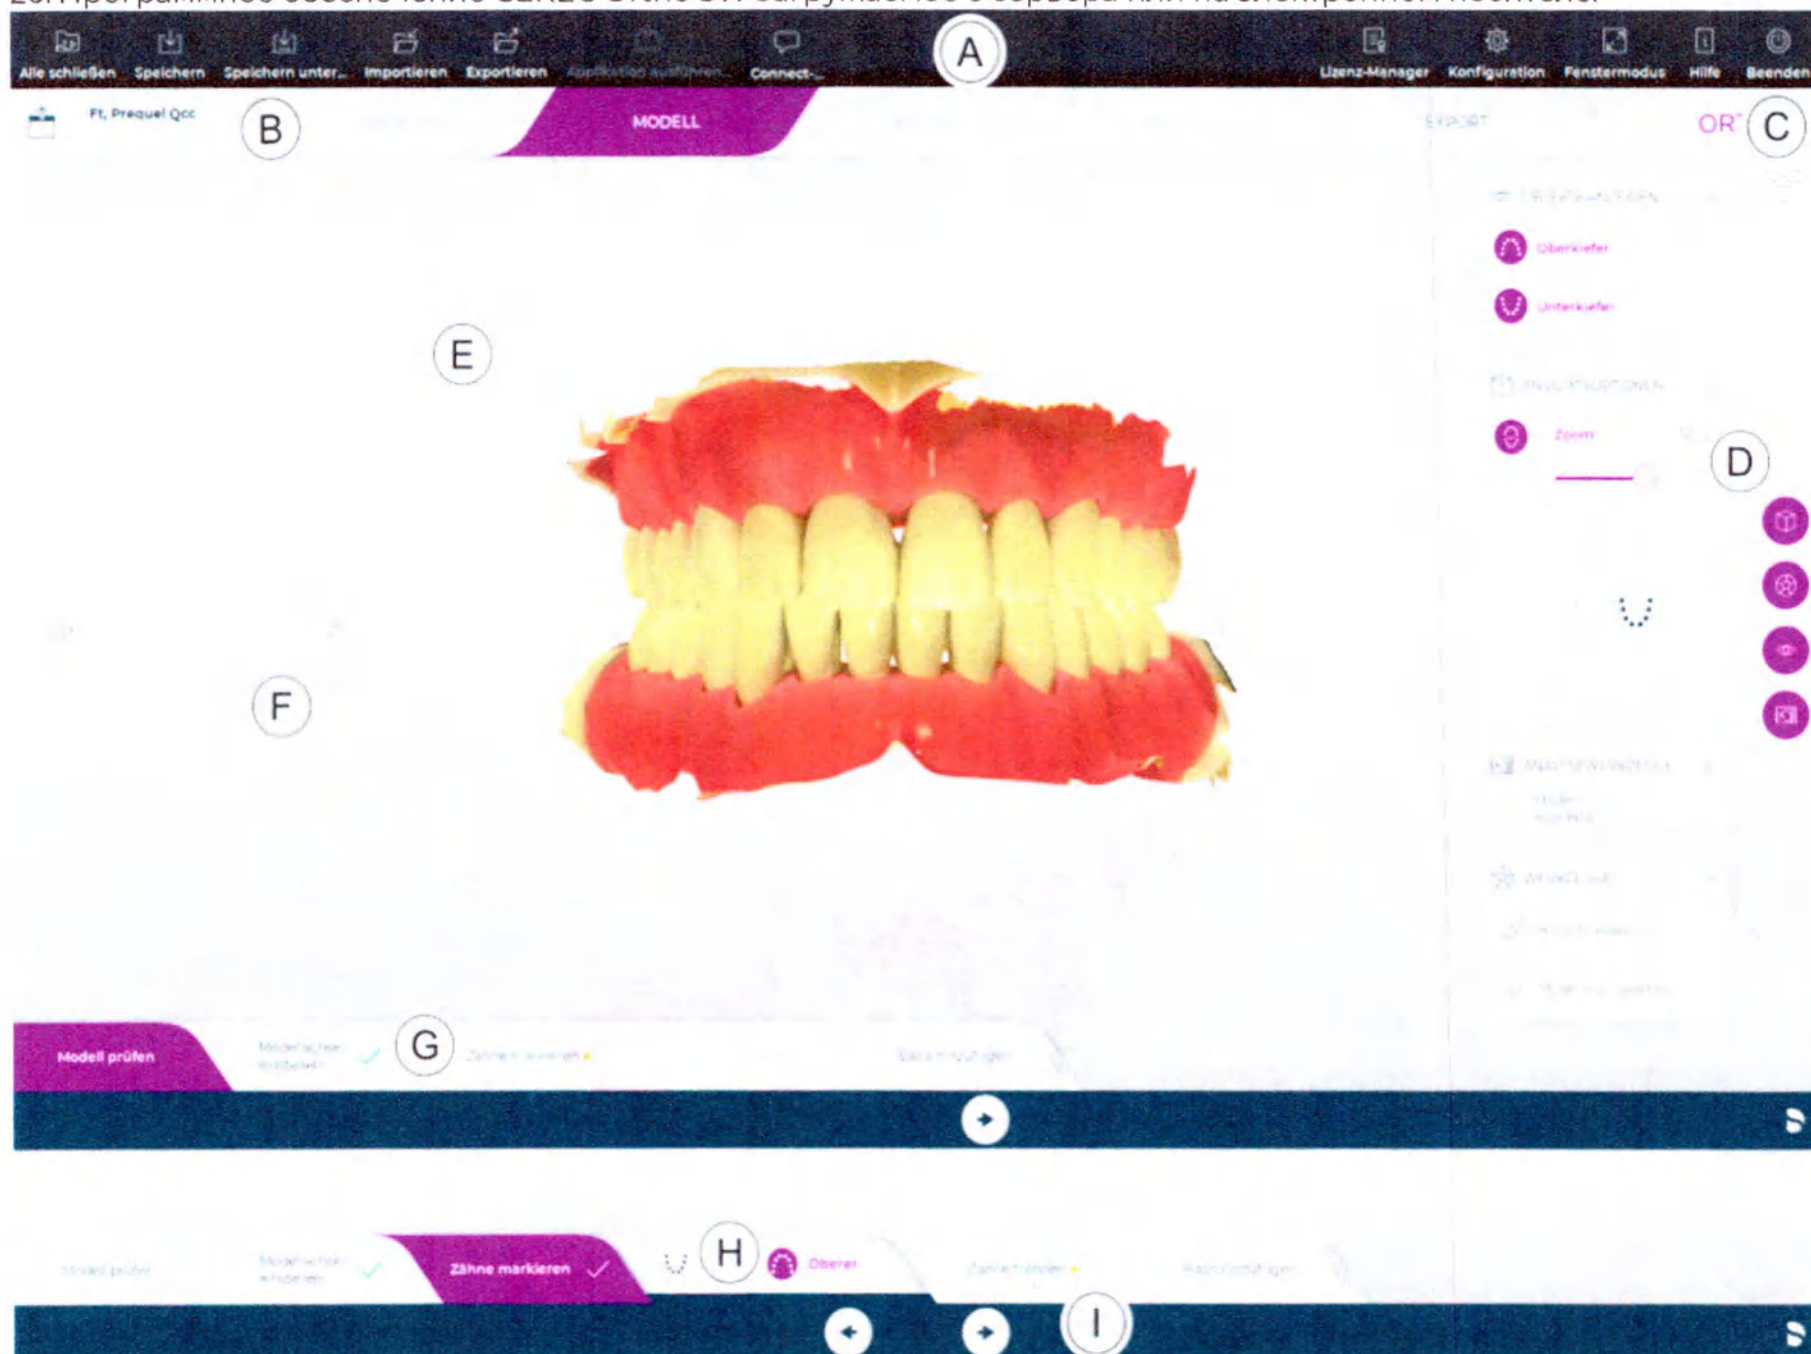

21. Программное обеспечение OraCheck загружаемое с сервера.

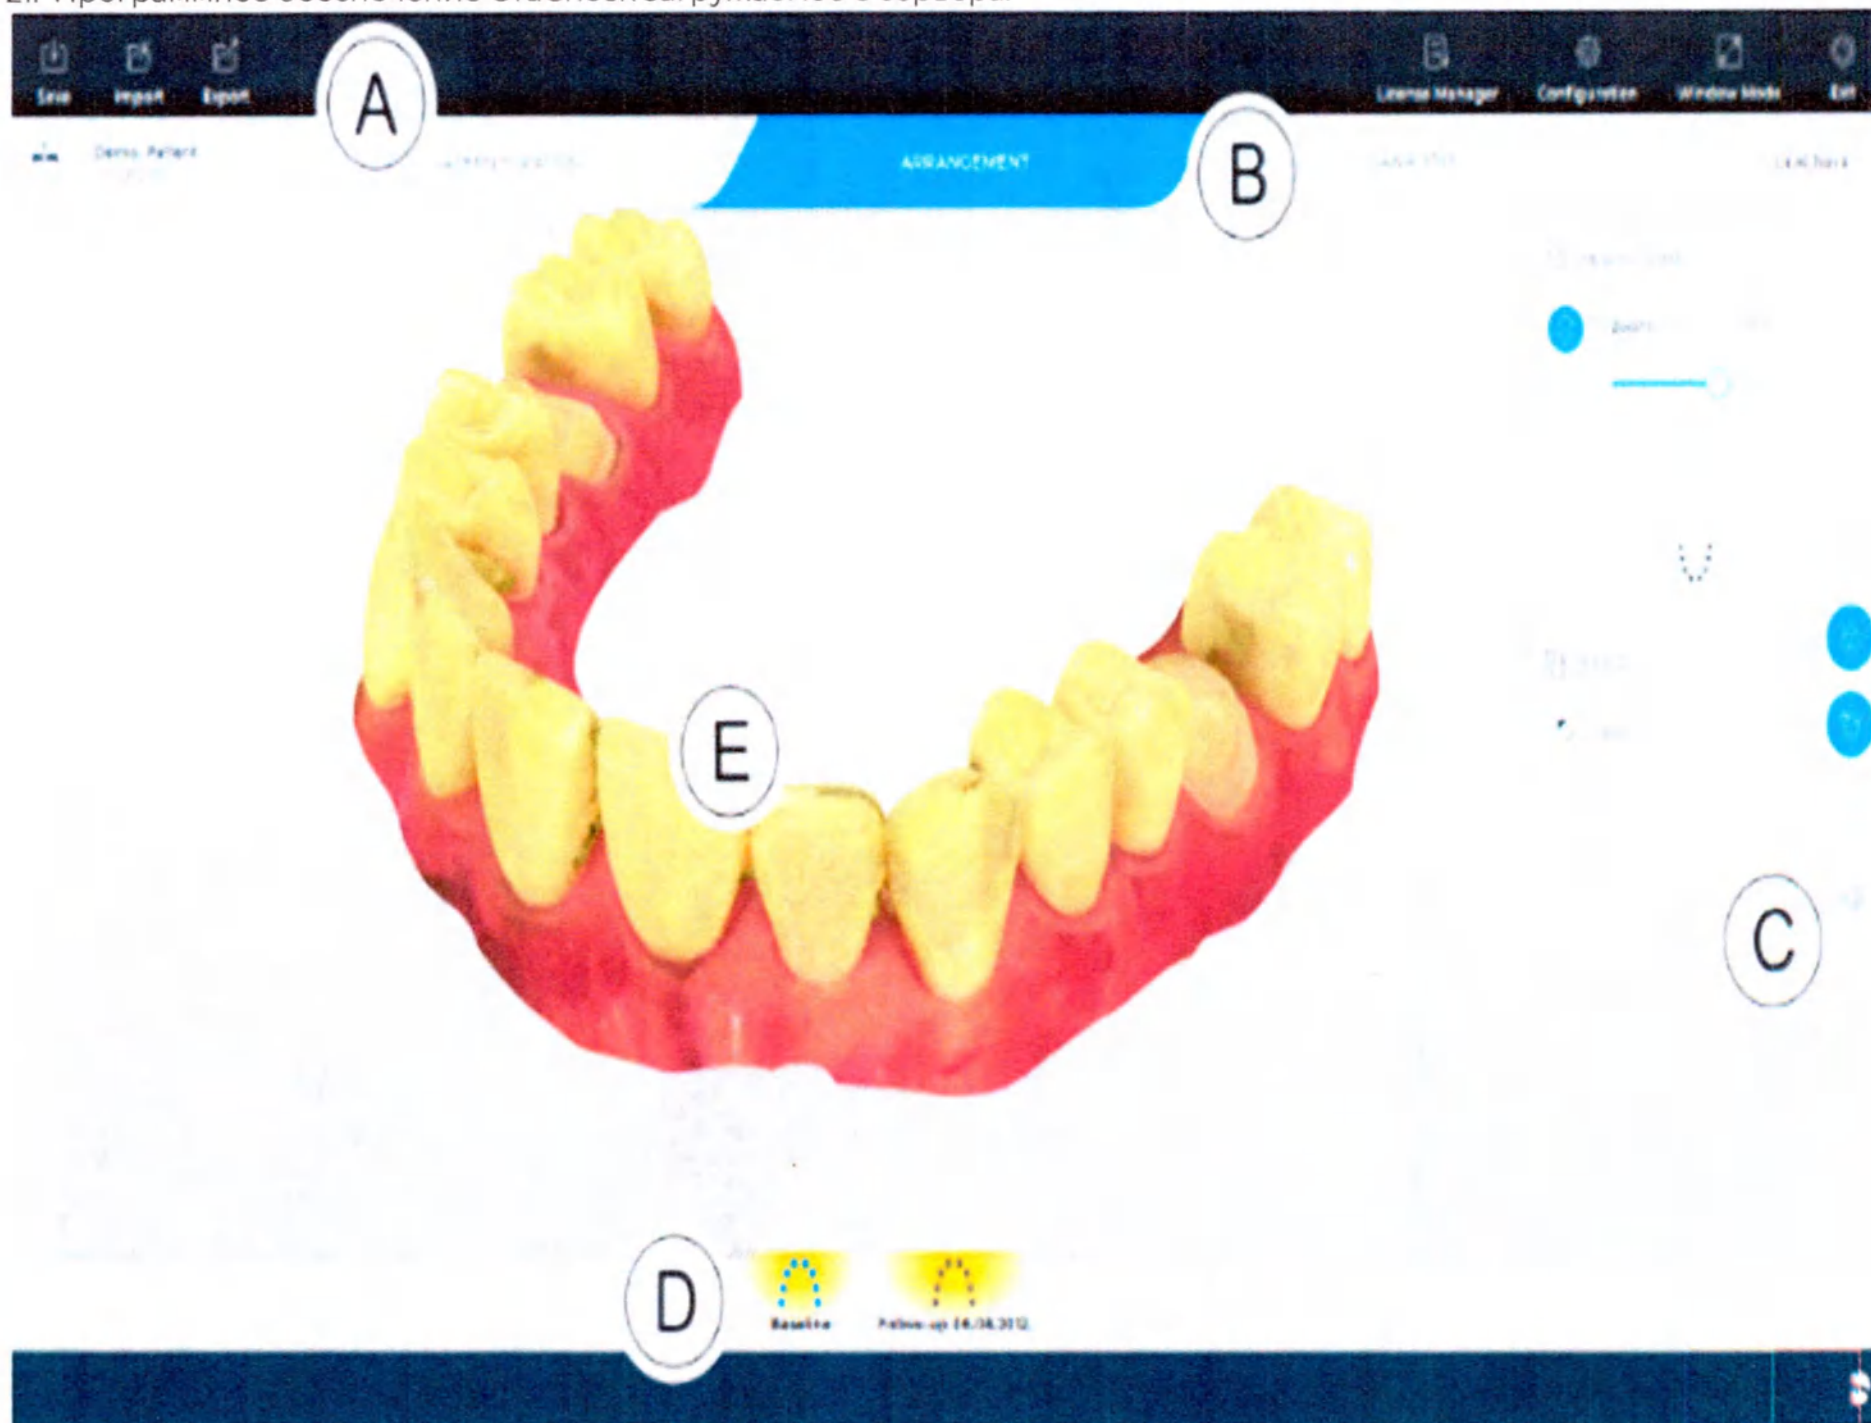


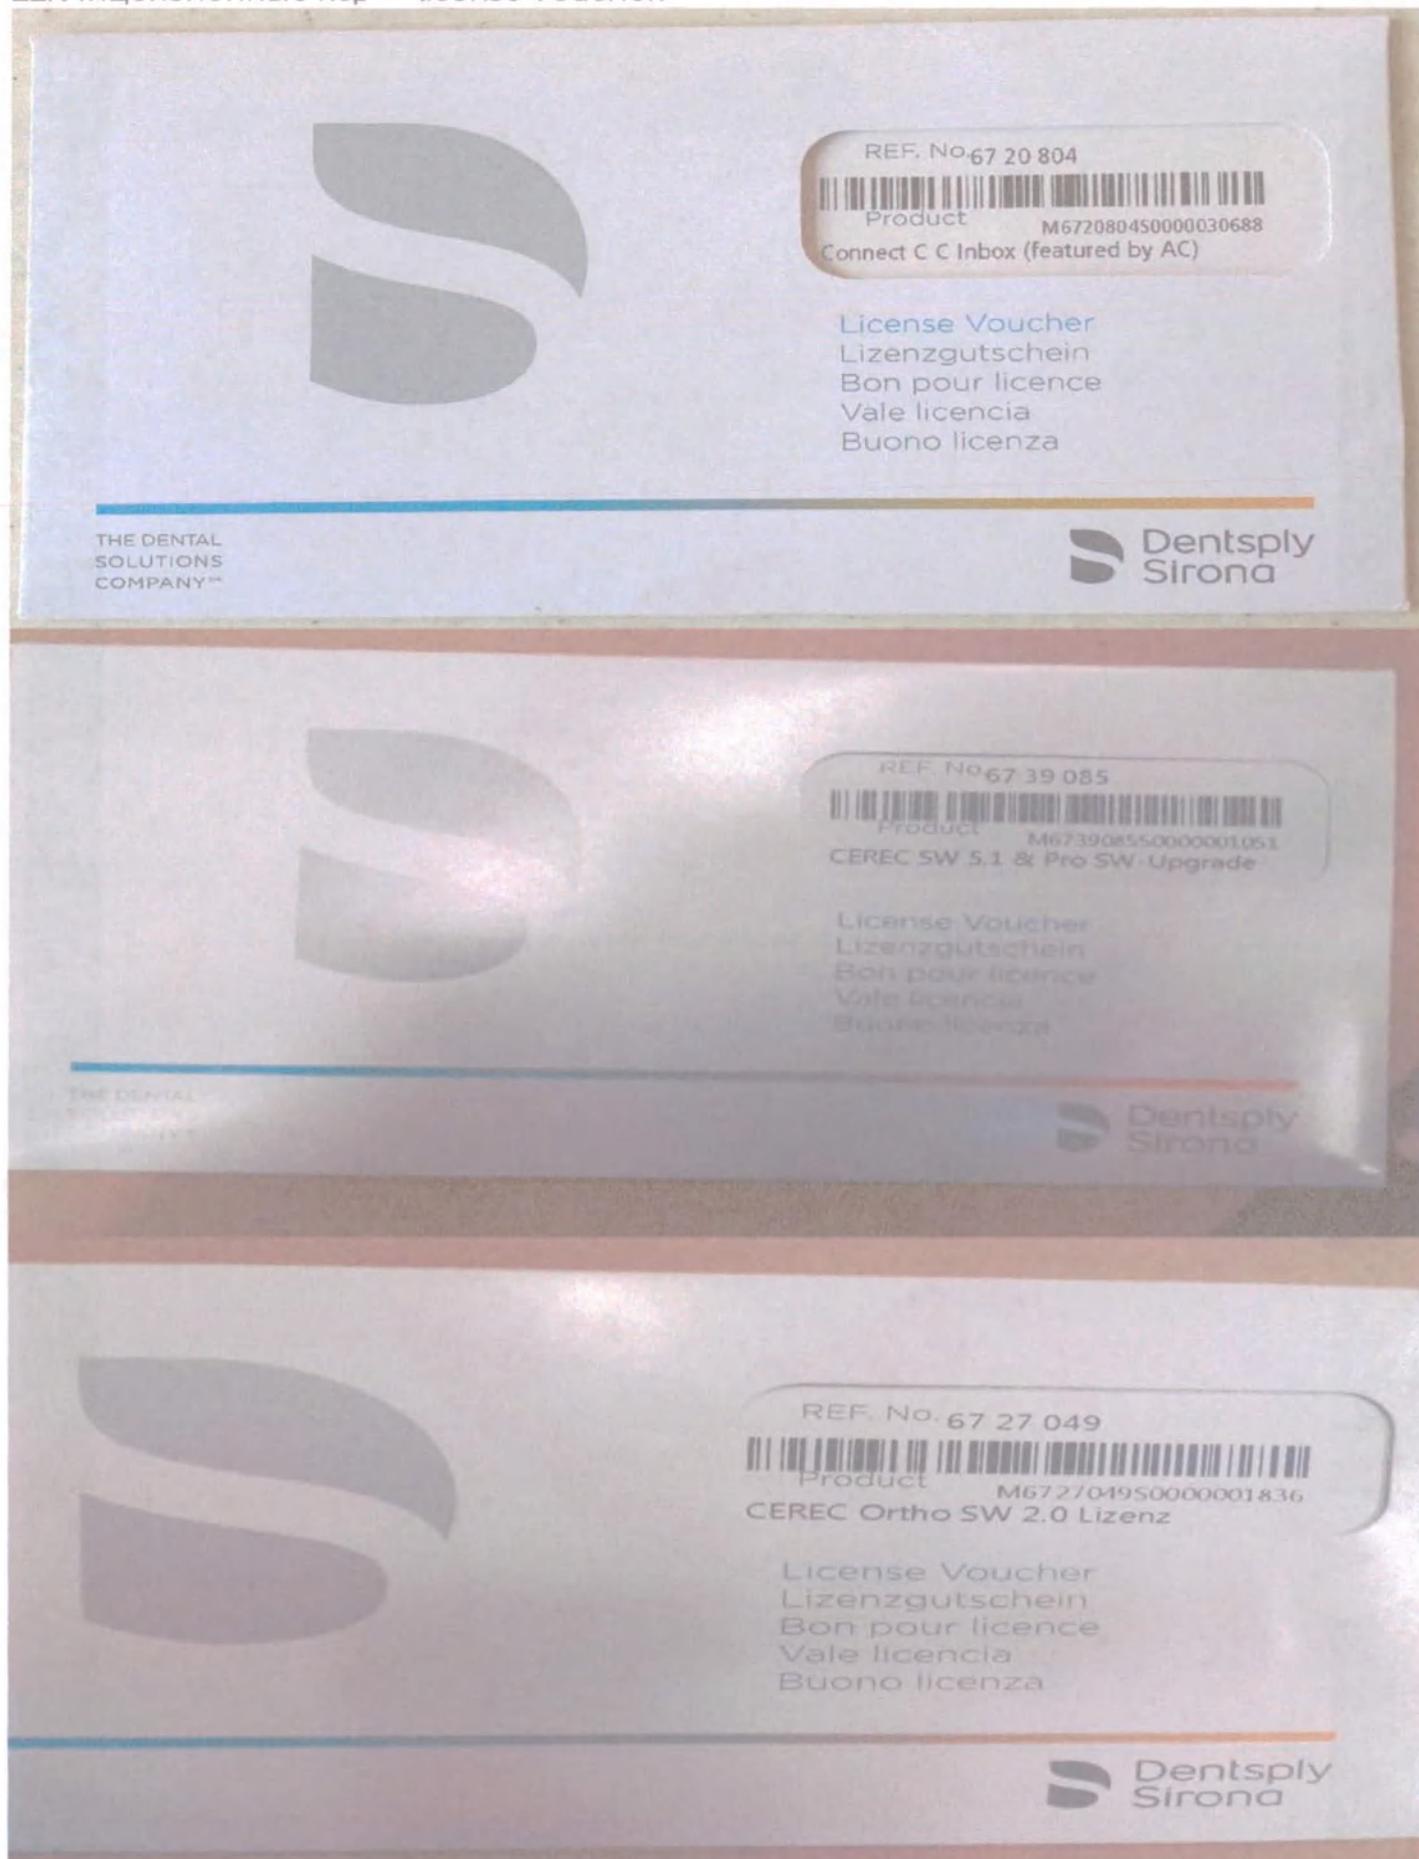

Primescan Connect Quick Start Guide

To start using your new Primescan Connect please follow these steps.

- 1 Turn on your laptop by following the windows instructions
- 2 Make sure your laptop is connected to the internet
- 3 To send codes to kits via the Connect Case Central, an account is needed. Accounts can be created in the Connect Portal
- 4 Set up your Primescan Connect by following the drawing below
- 5 After starting the laptop, launch the Connect Software by double-clicking on its icon
- 6 Calibrate your intraoral scanner using the kit included in the case and follow the instructions in the Connect Software
- 7 For the best scan results follow the instructions on the back side of this document
- 8 While scanning, make sure the laptop and the intraoral scanner are connected to the power supply. Do not disconnect the scanner while the Connect Software is running
- 9 For storage and sharing options access 3S Core
- 10 To automatically upload your scans in 3S Core open the System Monitor and log in
- 11 For more information, please scan the QR Code

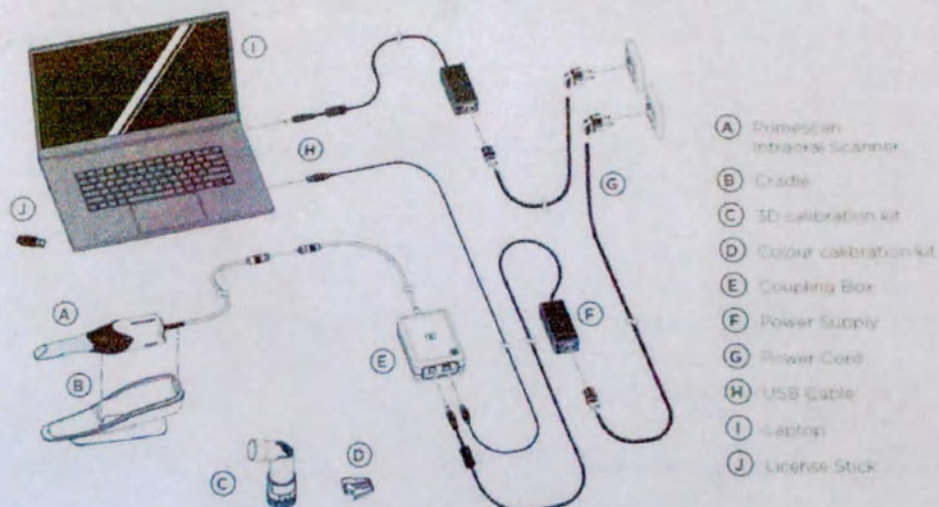

Link to the instructions for use: dentsplysirona.com/ifu

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

**Dentsply
Sirona**

24. Инструкция по эксплуатации, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе.



I. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan AC:



Primescan AC

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,
помещ. 3Н
тел.: +7 (495) 725 10 87

- II. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Primescan AC:



CEREC Primescan AC

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

**Уполномоченный
представитель:**

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2,
помещ. 3Н
тел.: +7 (495) 725 10 87

III. Аппарат стоматологический для получения и обрабо... цифровых
трехмерных моделей зубов в исполнении Omnicam AC:



Omnicam AC

**Аппарат стоматологический для получения и обработки
цифровых трехмерных моделей зубов**

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по
назначению представлена в инструкции по эксплуатации.
Информация об условиях транспортировки и хранения
представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ.
ЗН
тел.: +7 (495) 725 10 87

IV. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC Omnicam AC:



CEREC Omnicam AC

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.

Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д.
18/1, стр. 2, помещ. 3Н
тел.: +7 (495) 725 10 87

V. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Omnicam.



CEREC AF Omnicam

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

VI. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении CEREC AF Connect Omnicam.



CEREC AF Connect Omnicam

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.

Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

VII. Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов в исполнении Primescan Connect.



Primescan Connect

Аппарат стоматологический для получения и обработки цифровых трехмерных моделей зубов

РУ № РЗН 2019/9420 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации.

Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции.

Производитель:

Sirona Dental Systems
GmbH
(Сирона Дентал Системс
ГмбХ)
Fabrikstrasse. 31, 64625
Bensheim, Germany
(Германия)

Уполномоченный представитель:

ООО «Сирона Денталь Системс»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Замоскворечье, наб.
Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н,
тел.: +7 (495) 725 10 87

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 96 лист (ов)

 К.Г. Левин

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

