

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Элторг»



Гольцман Д.Л.

2021 г.


АППАРАТ МАТРИЧНЫЙ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
НА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ И ТКАНИ ELMEDLIFE, В ВАРИАНТАХ
ИСПОЛНЕНИЯ по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

г. Нижний Новгород

2021


1. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife H

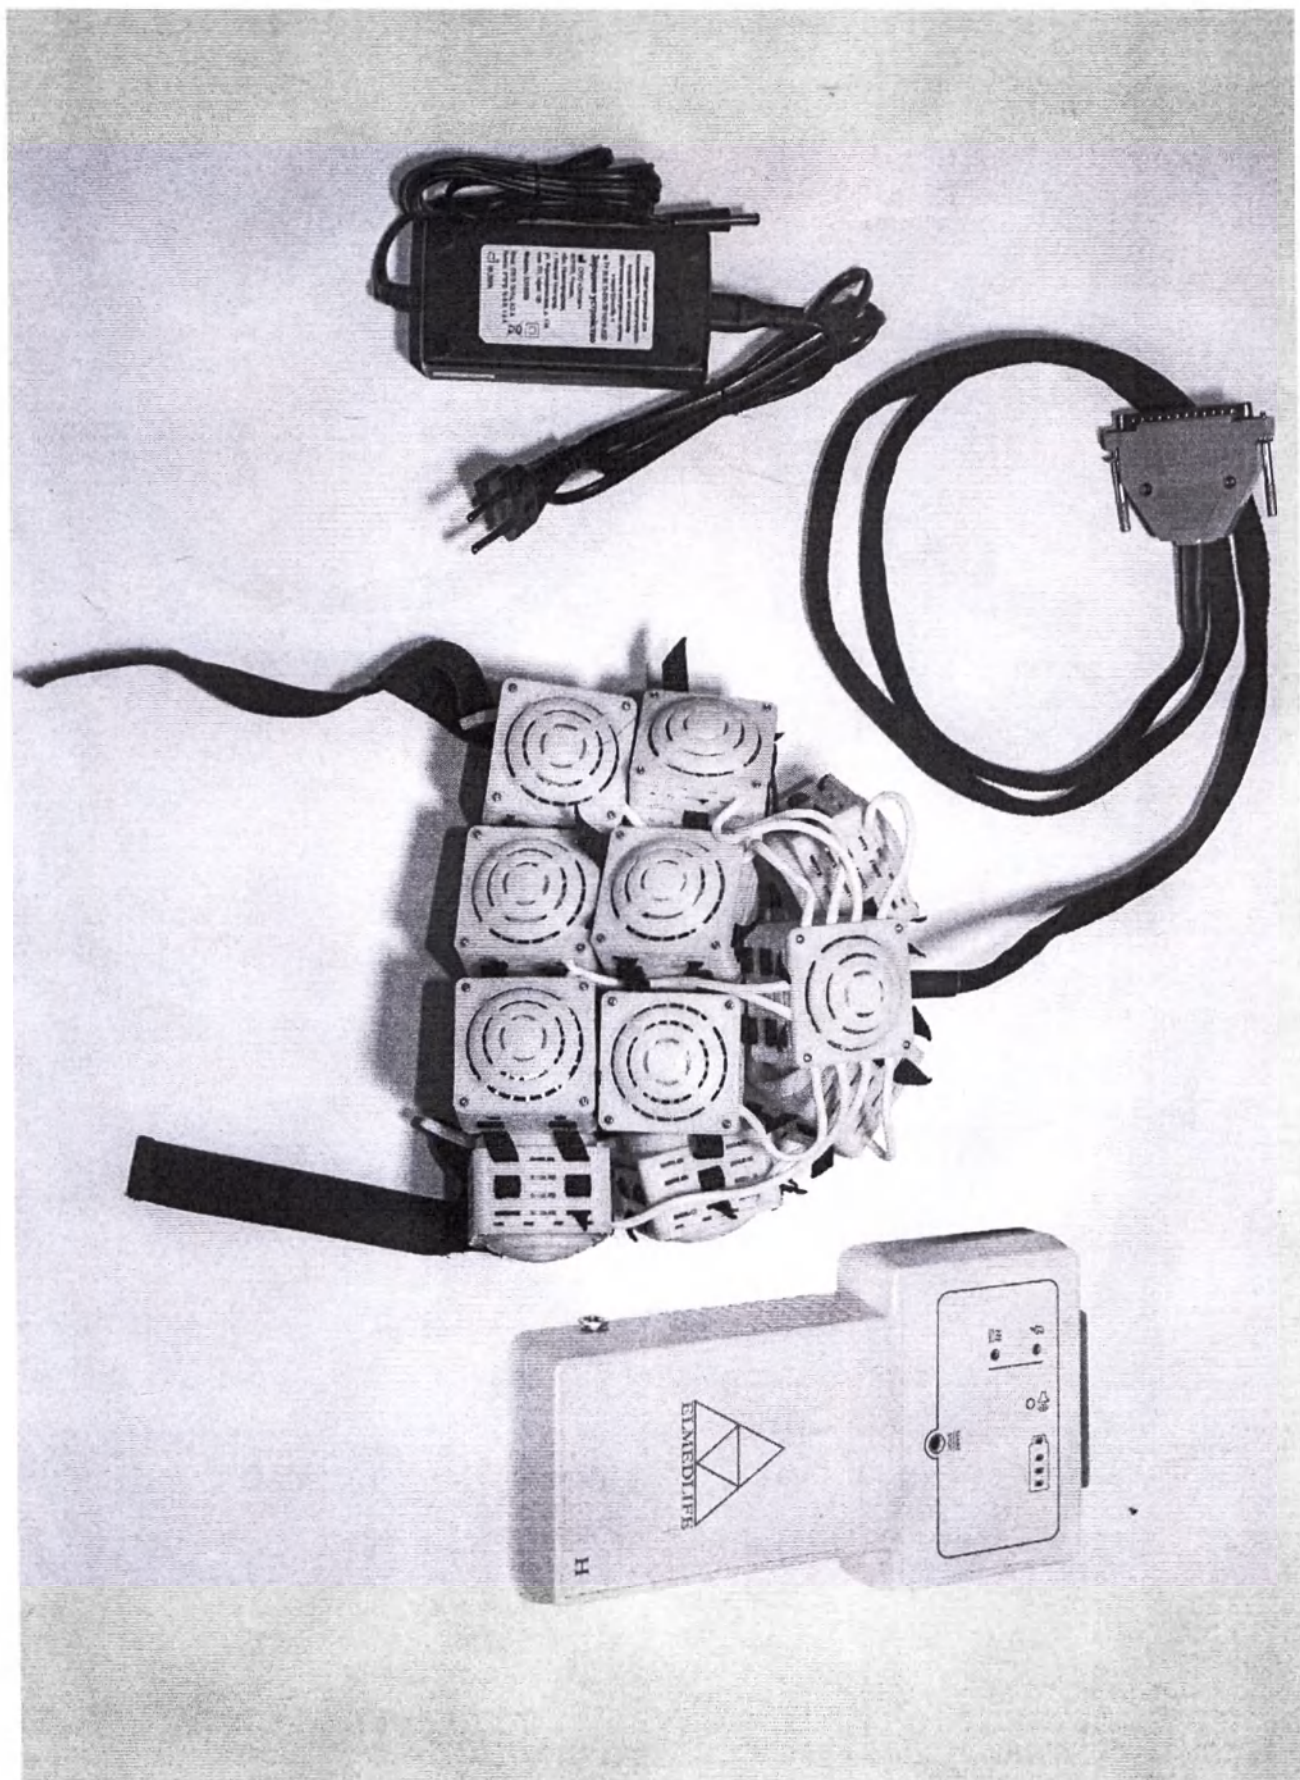


1.1. Шлем-гарнитура Elmedlife H



1.2. Блок управления Н

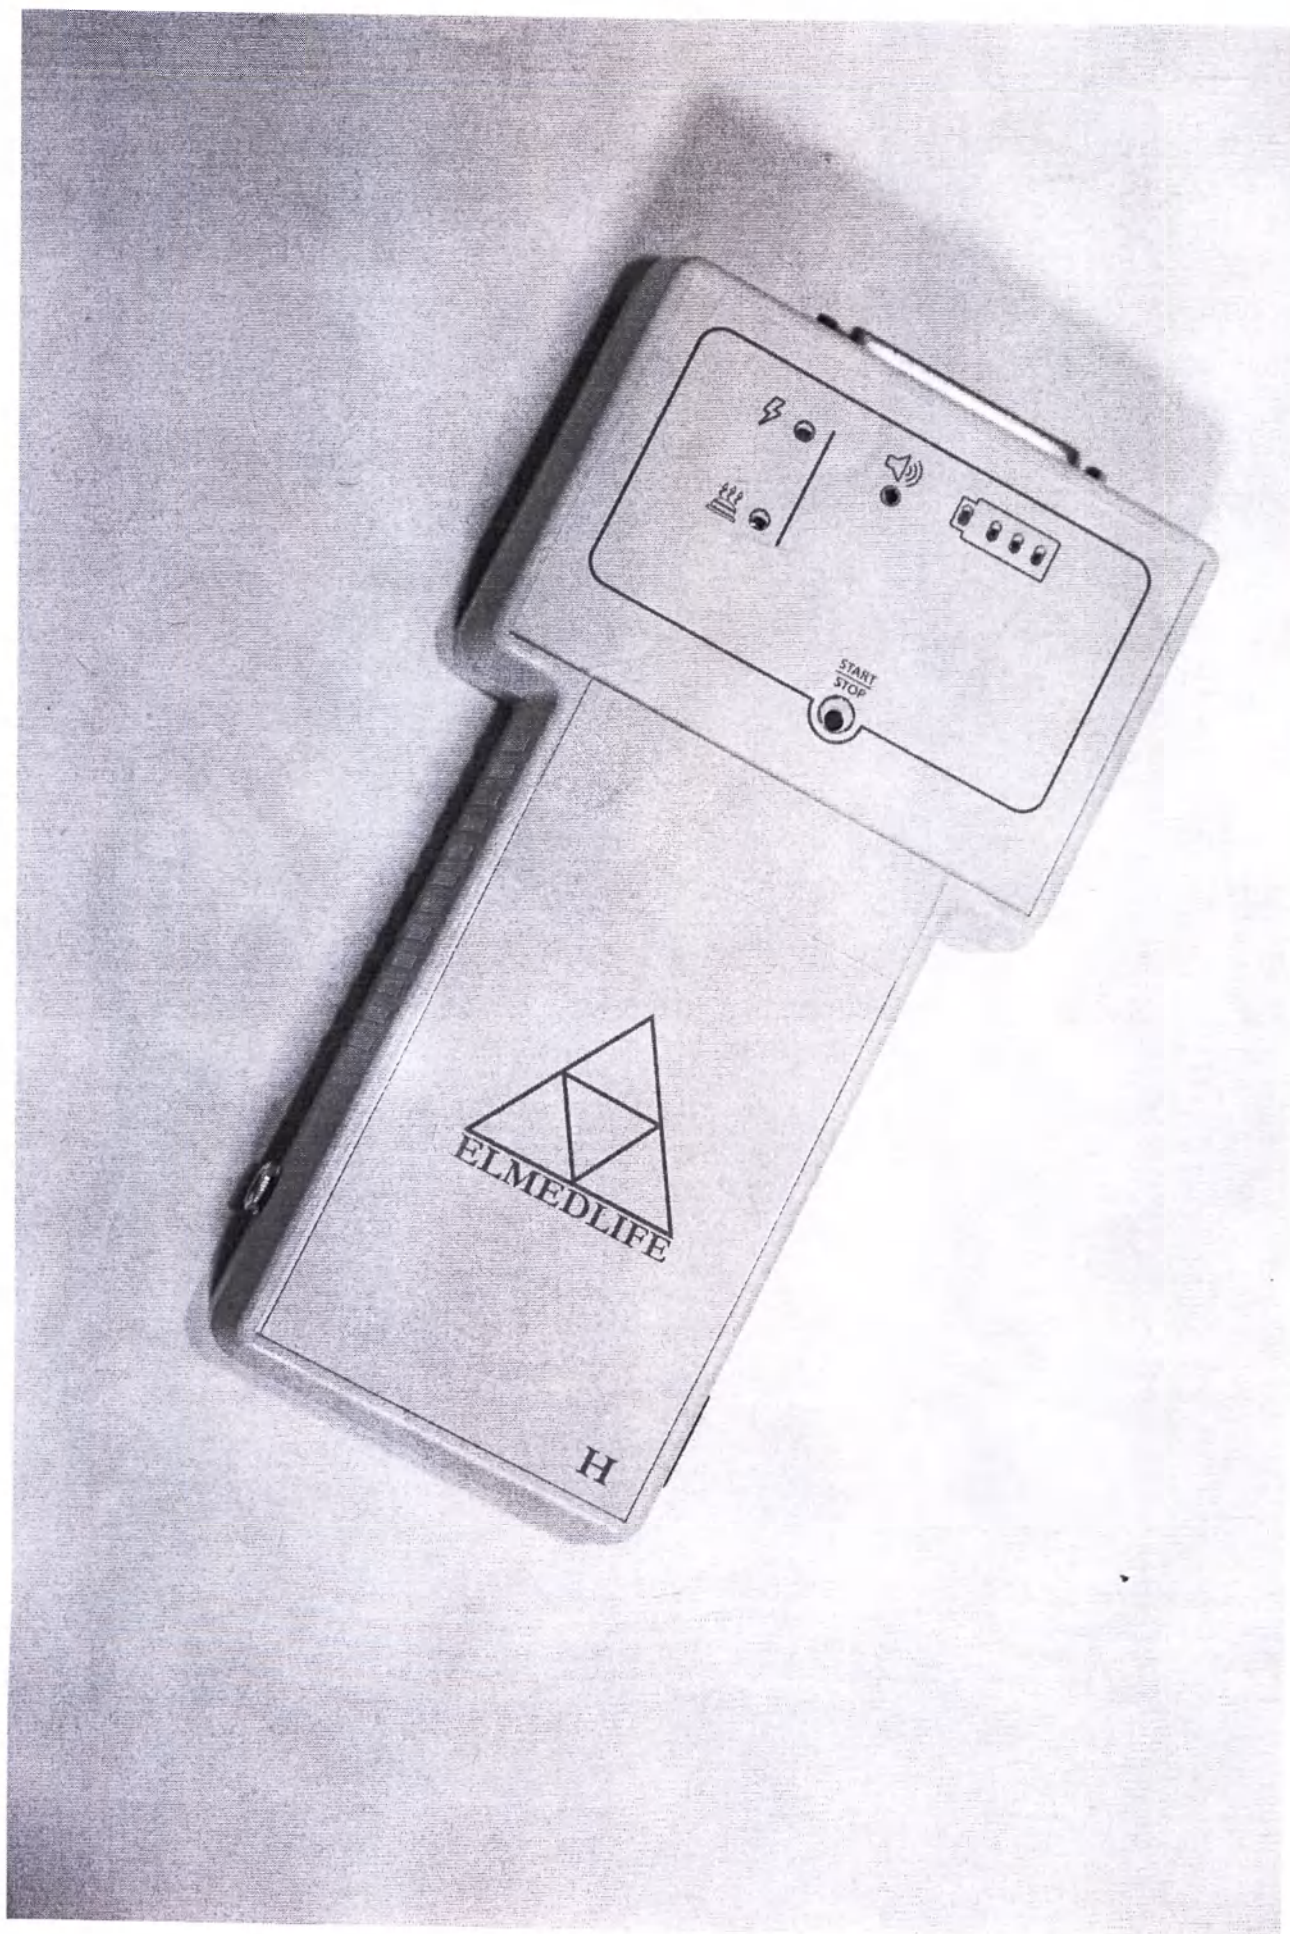

1.3. Зарядное устройство

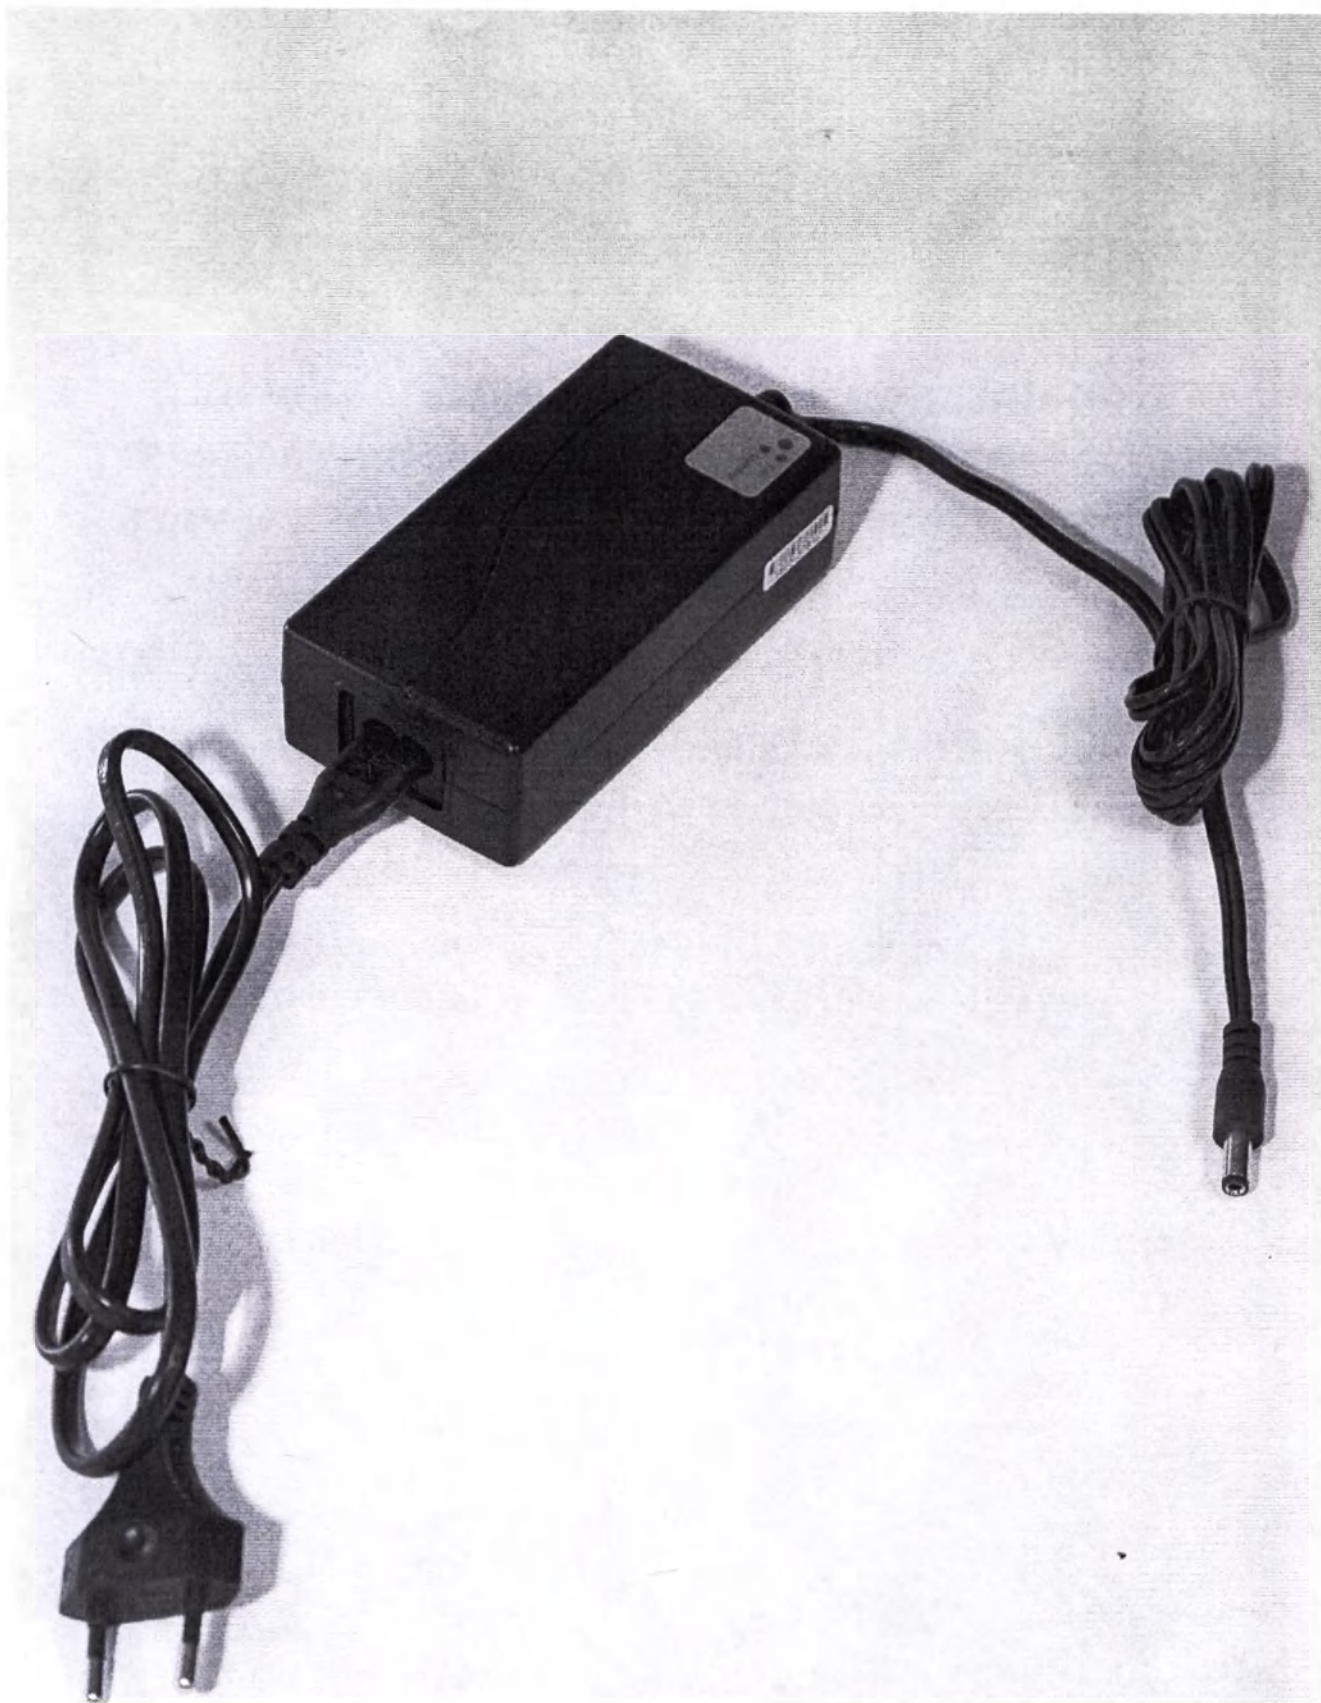

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife H**




ООО «Элторг»


603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0001



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife H**

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»
603105, Россия,
обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород,
ул. Агрономическая, д. 134,
пом. П1, офис 106

Модель: E318553


Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А




05.2020г.


2. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife L

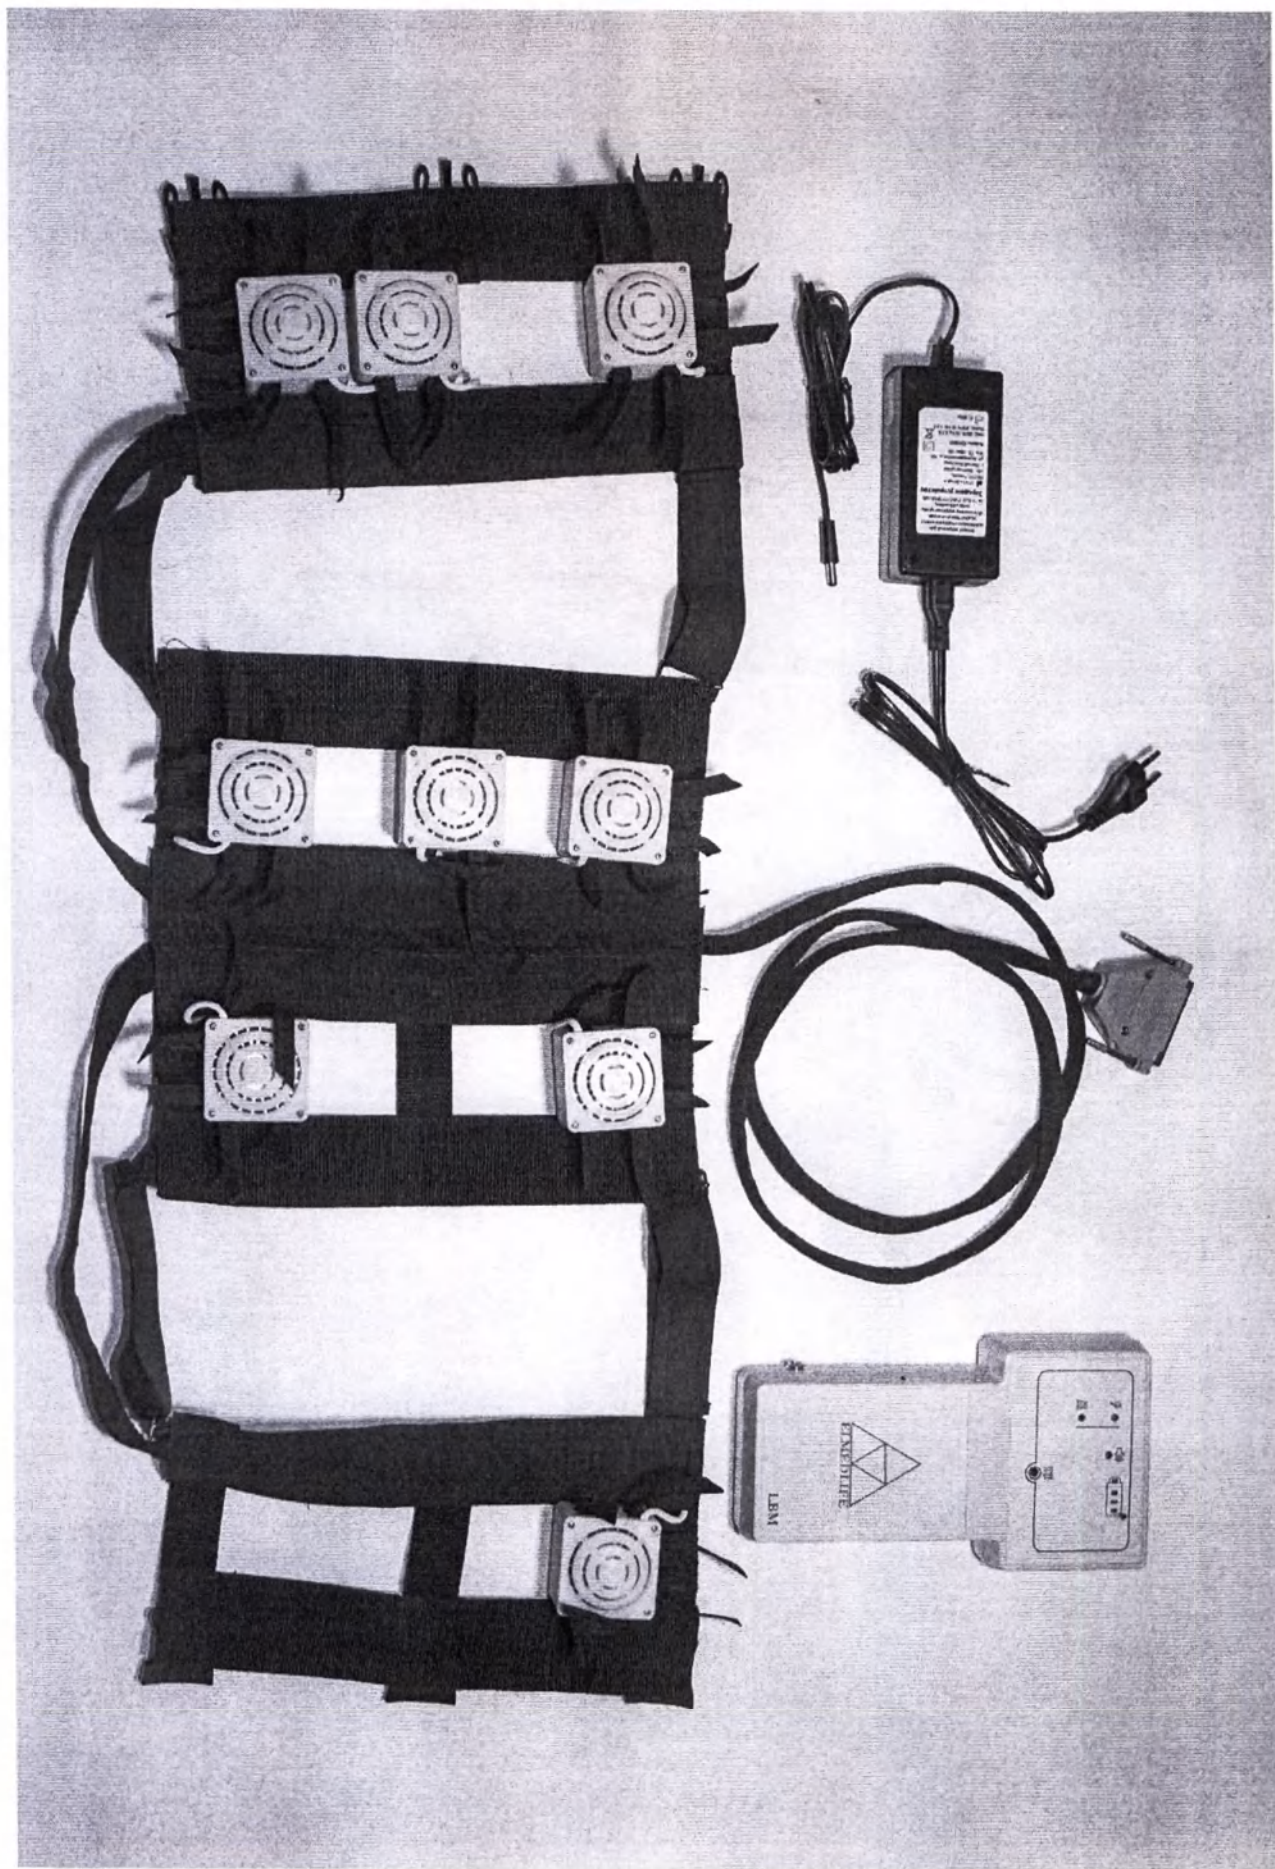


2.1 Жилет-гарнитура Elmedlife L

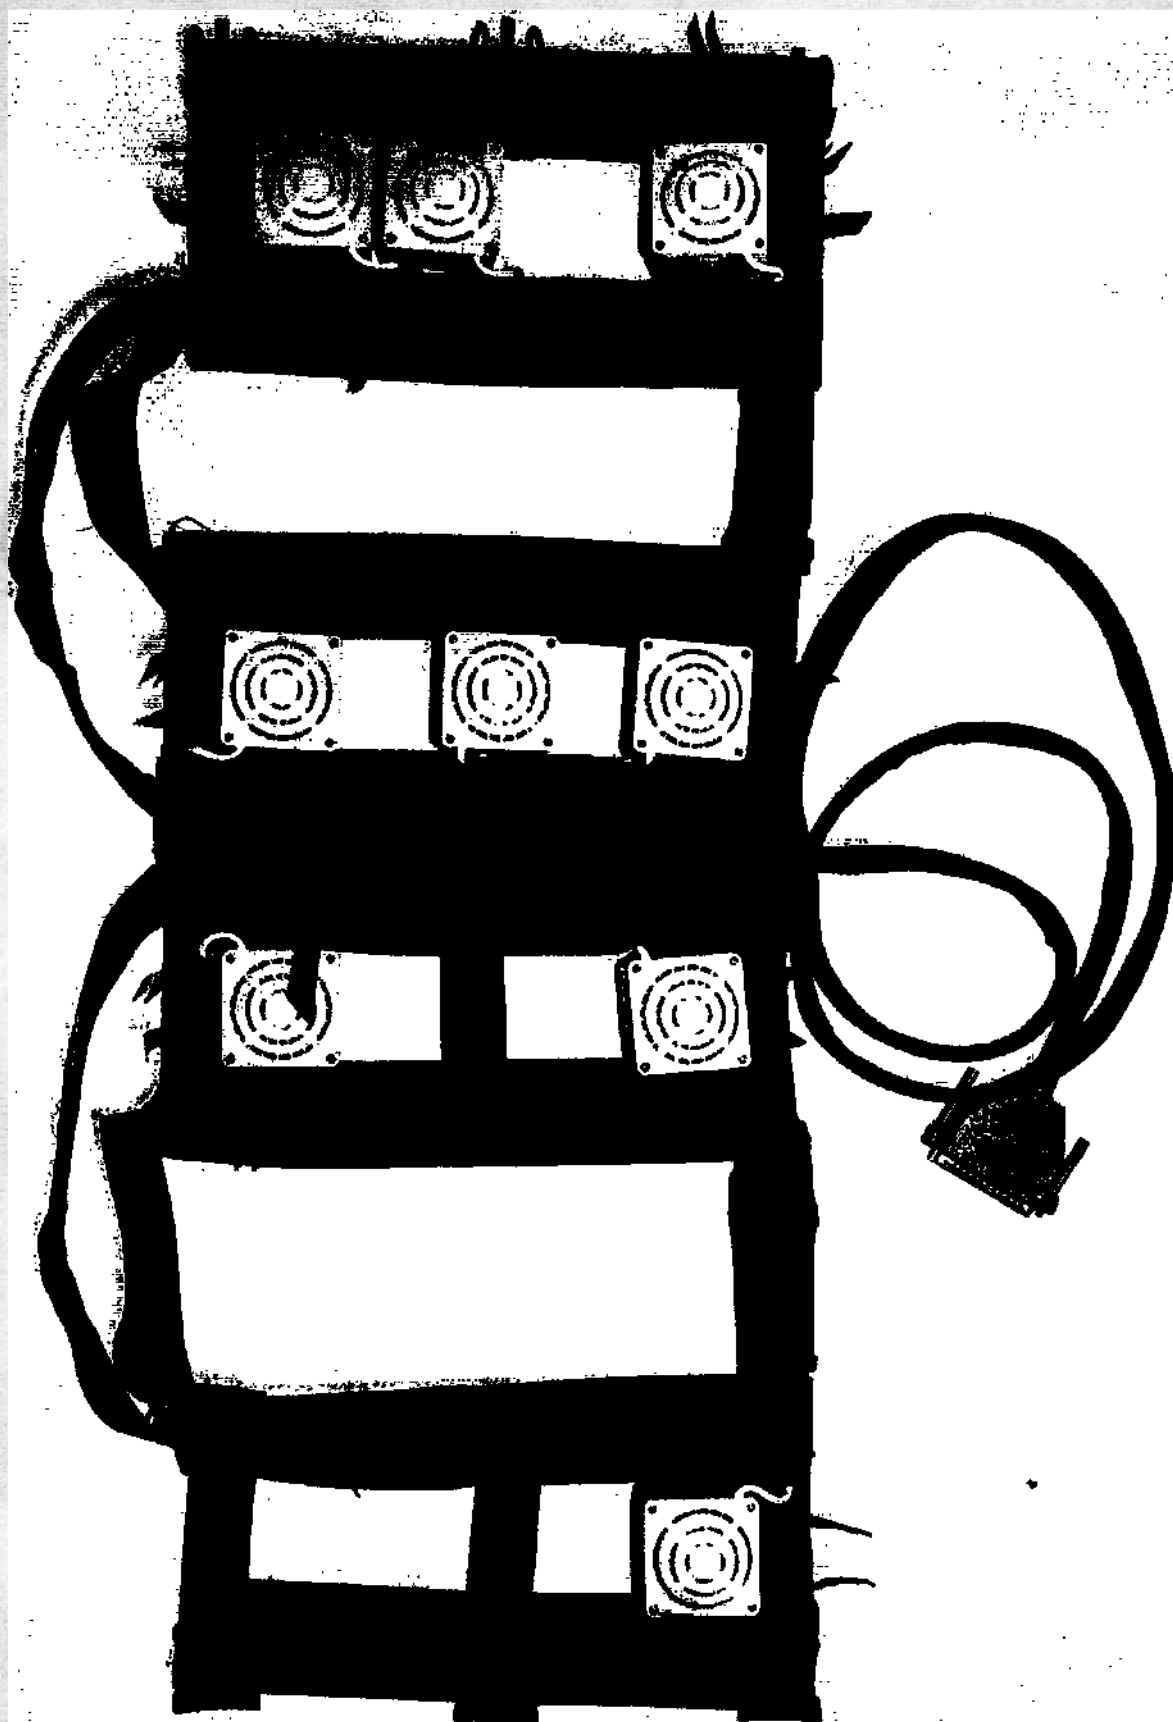

2.2 Блок управления LBM

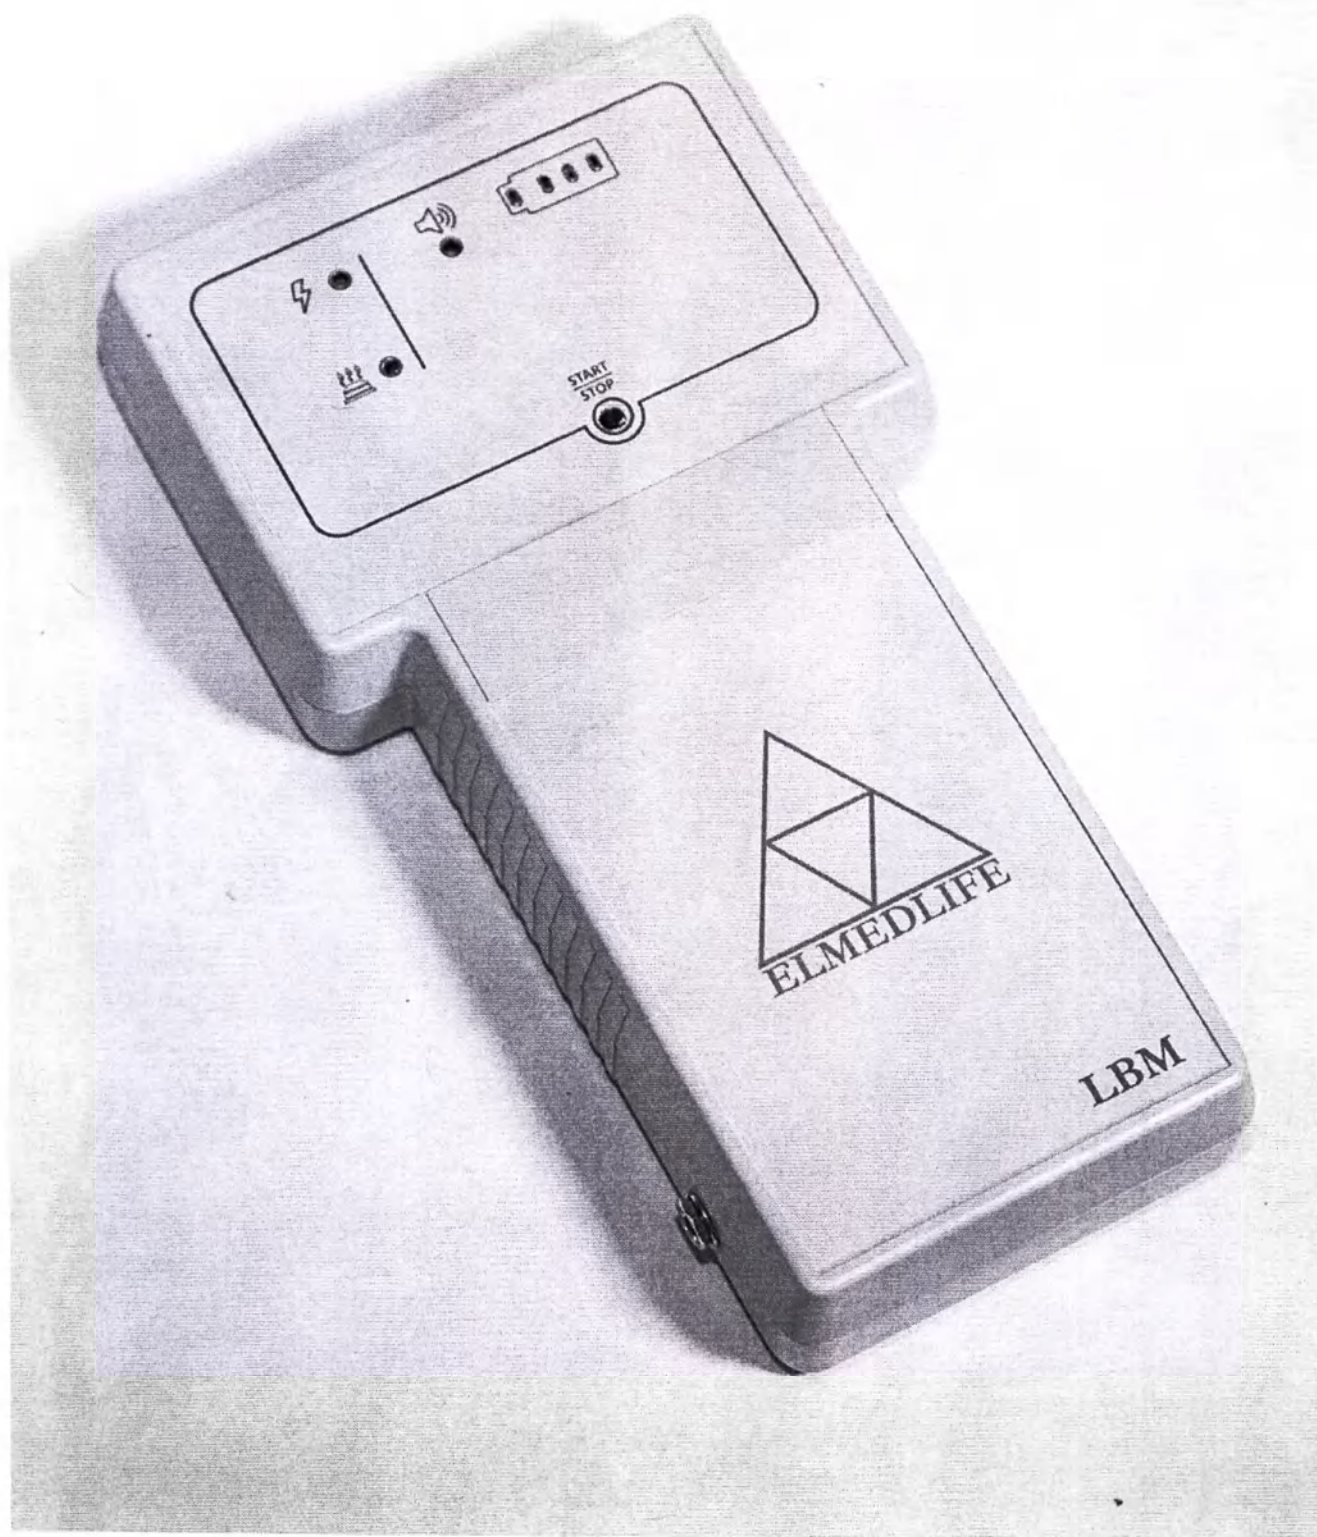

2.3 Зарядное устройство

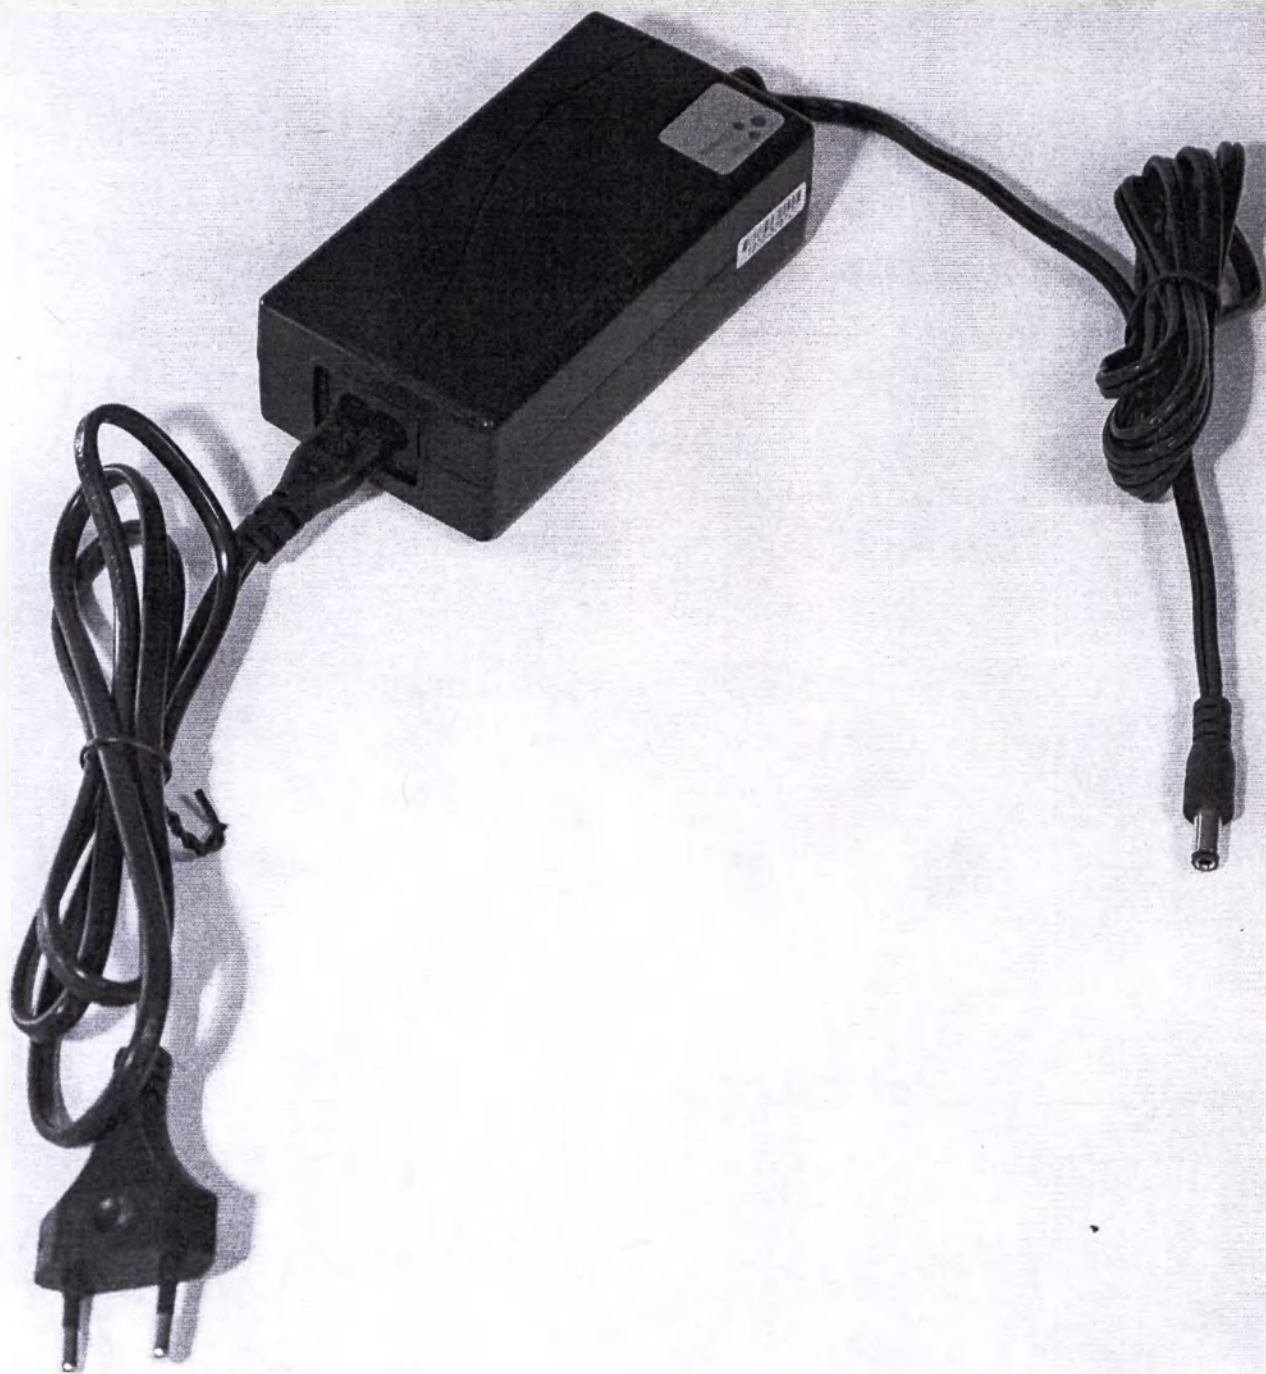

Маркировка на блоке управления LBM Аппарата матричного для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife L

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife L**




ООО «Элторг»


603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0002



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife L**

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»

603105, Россия,

обл. Нижегородская,

г. Нижний Новгород,

ул. Агрономическая, д. 134,

пом. П1, офис 106

Модель: E318553


Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А




05.2020г.


3. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife B

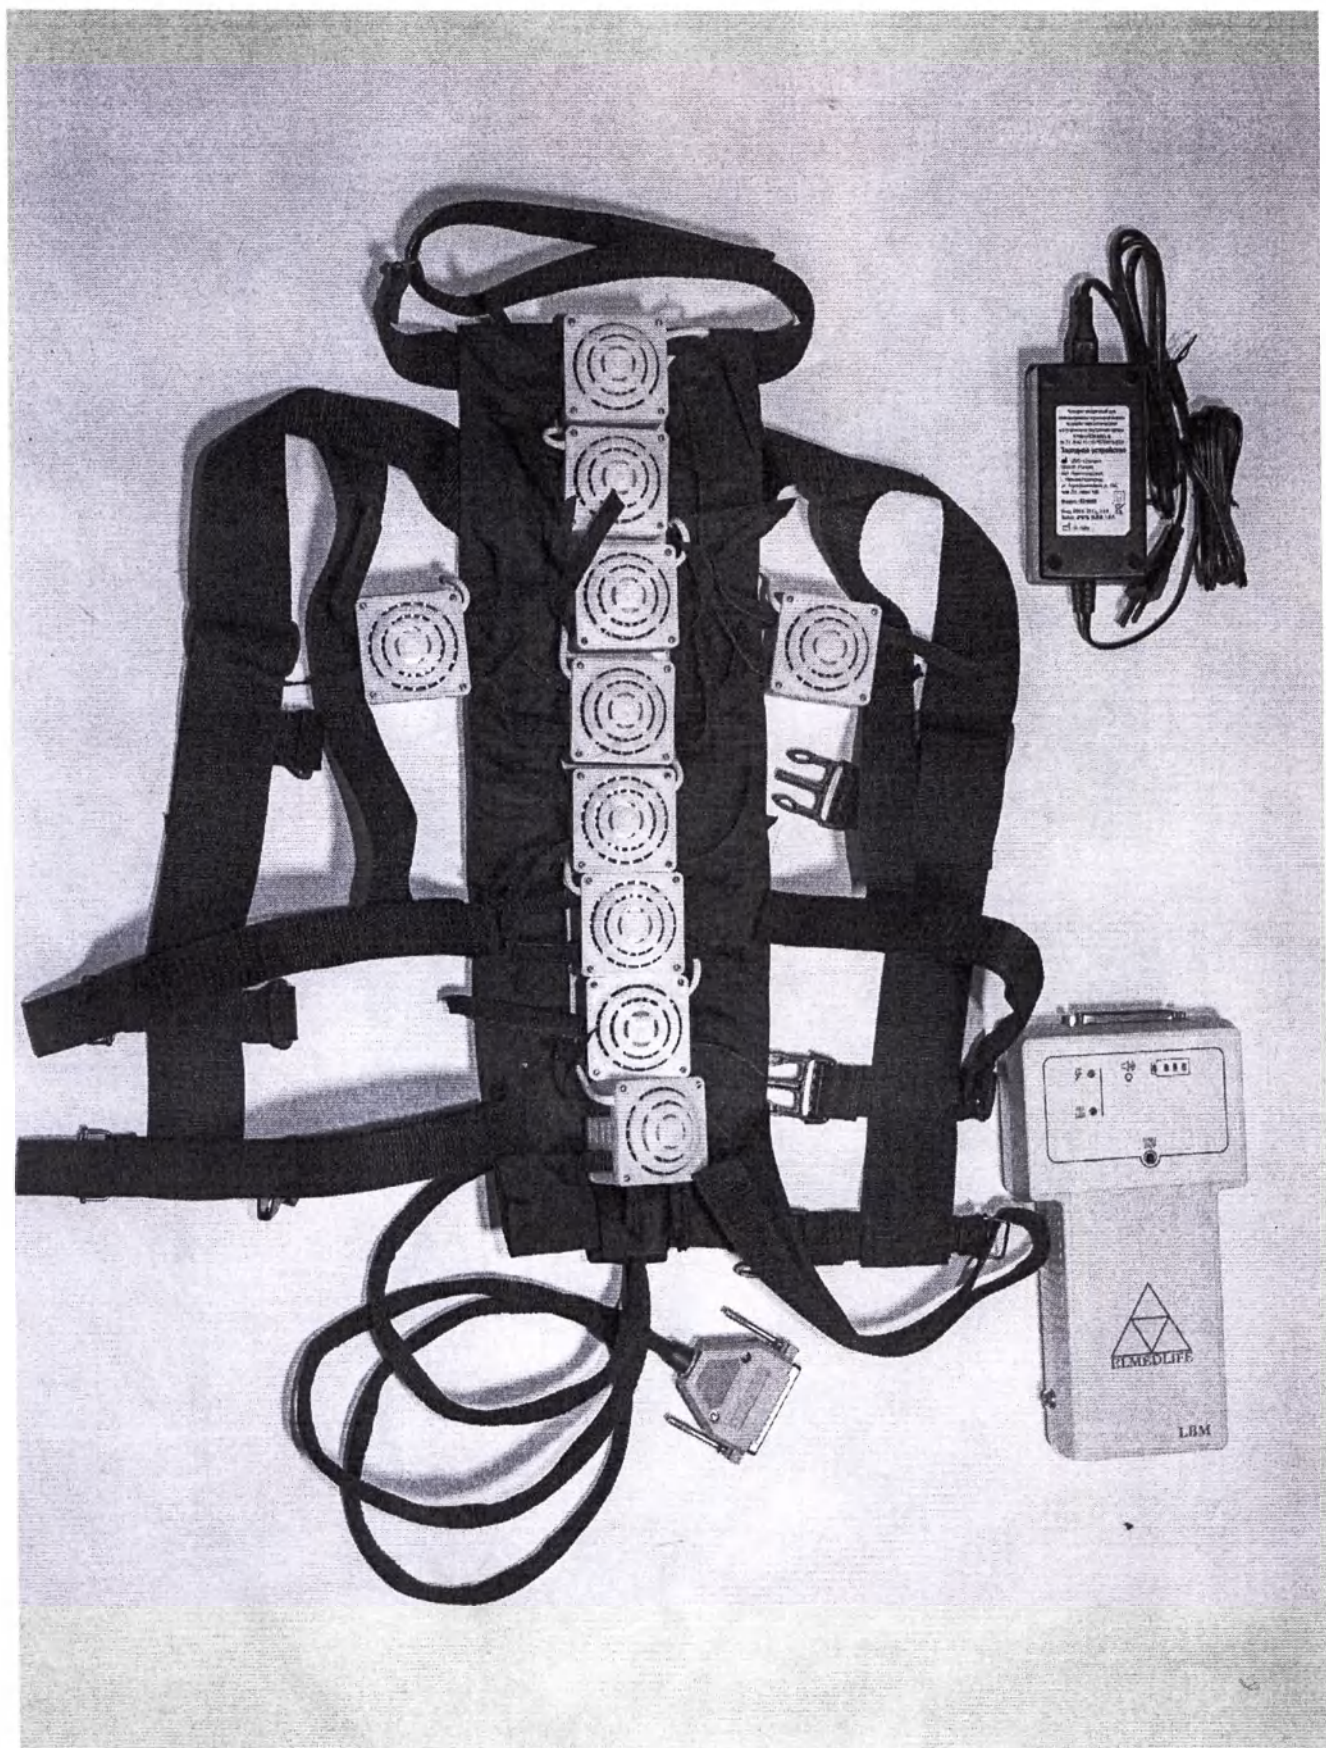


3.1 Жилет-гарнитура Elmedlife B

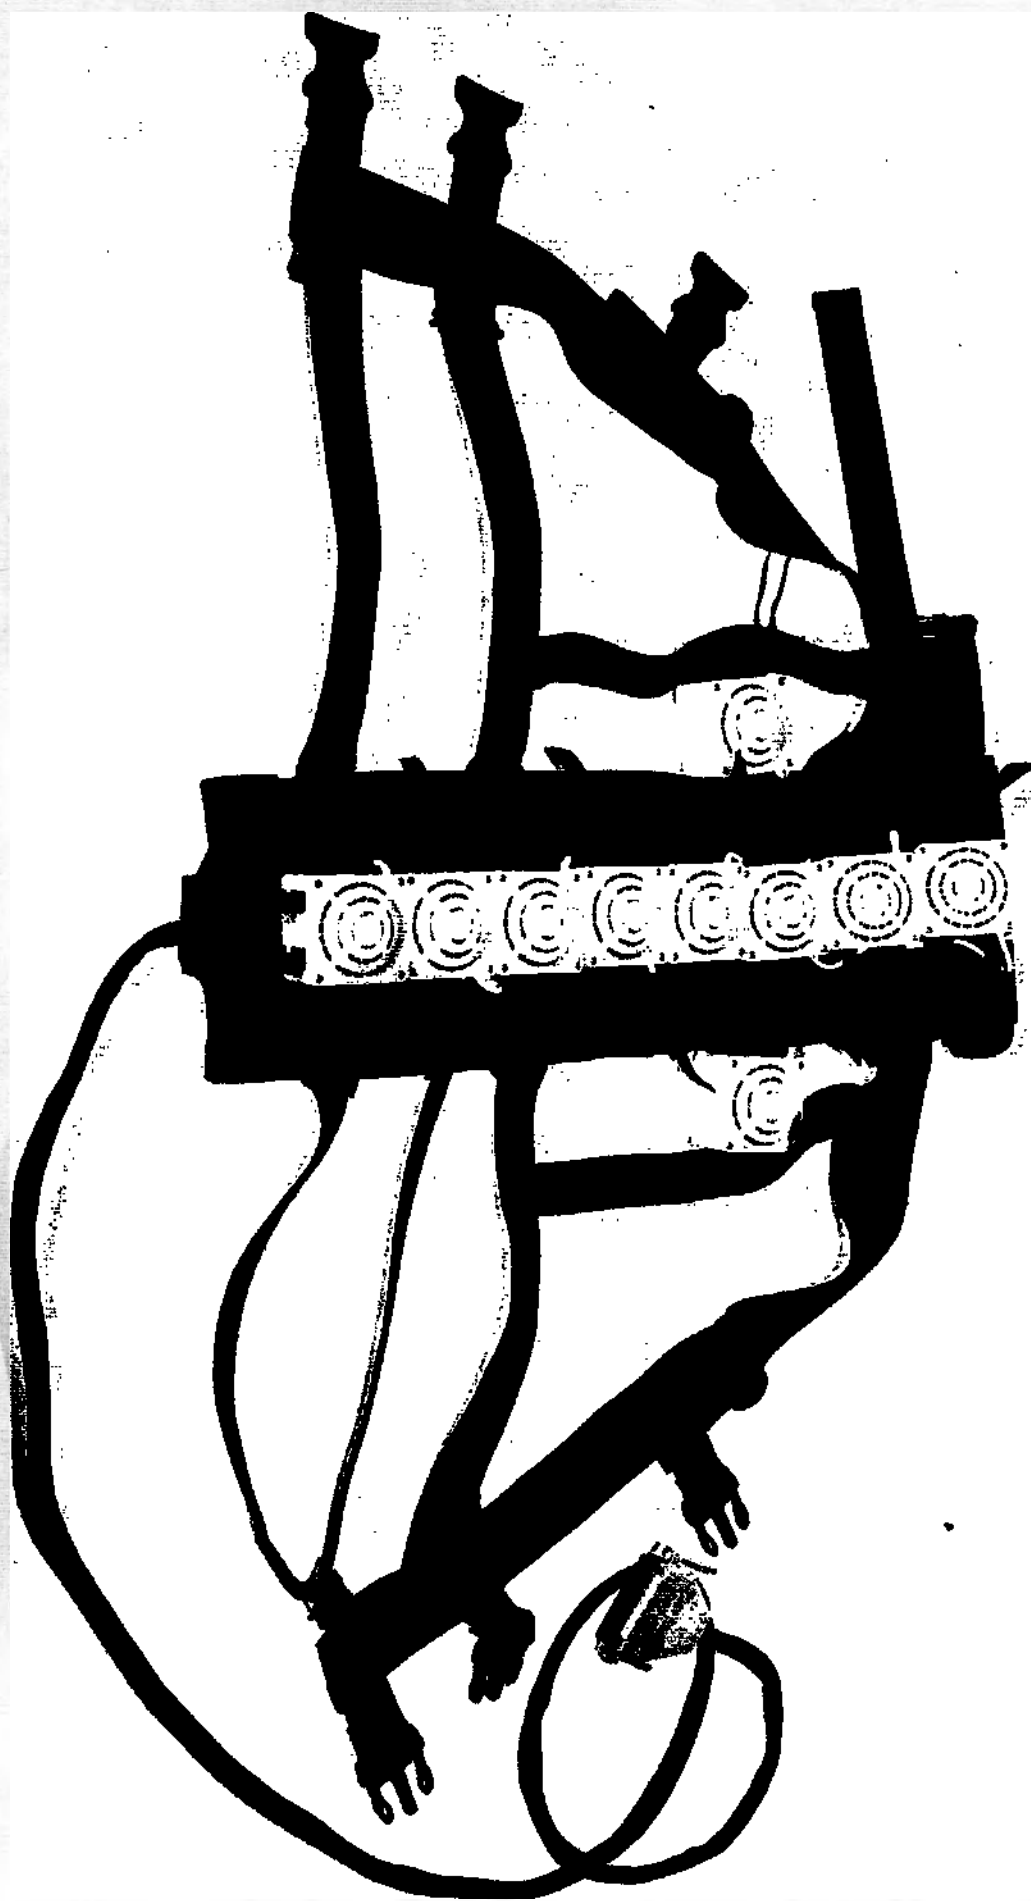

3.2 Блок управления LBM

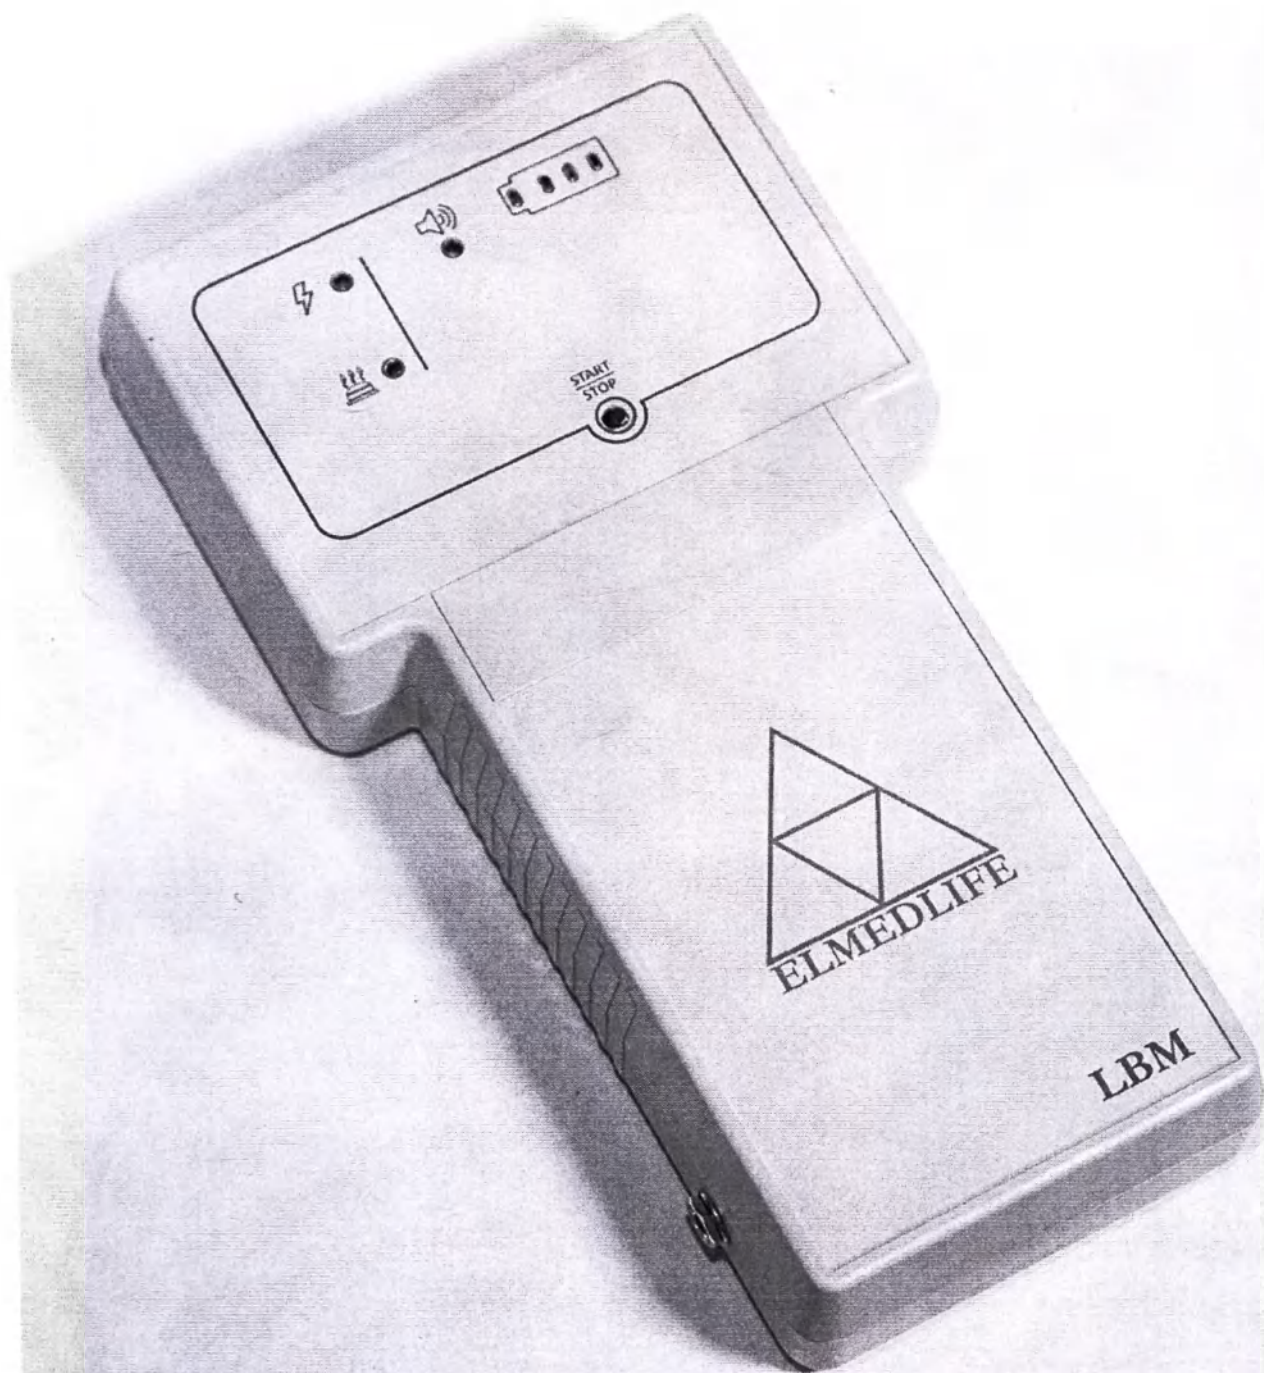

3.3 Зарядное устройство

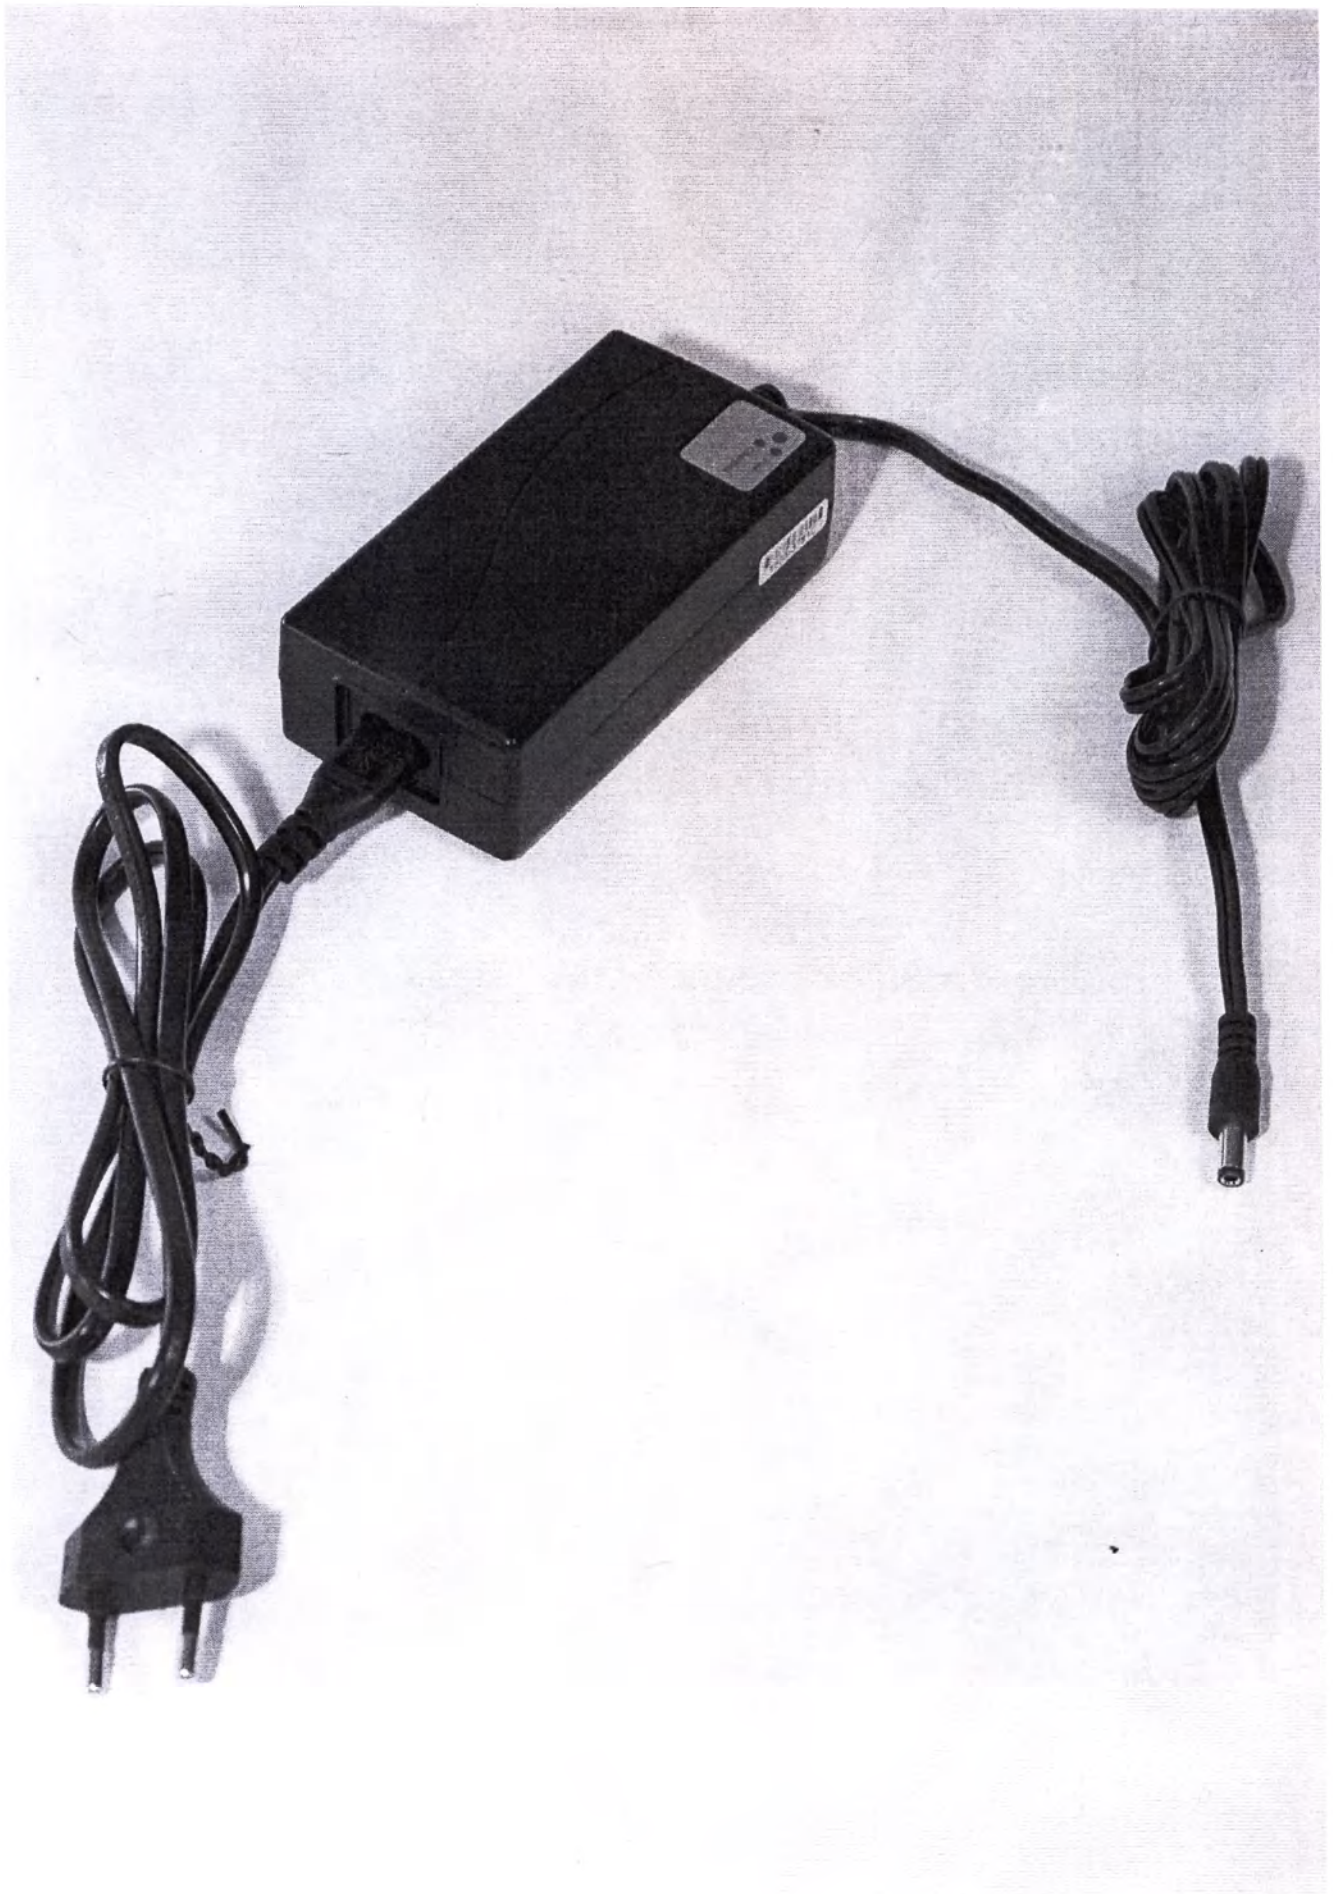

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife B**




ООО «Элторг»

603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0003



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife B**

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»

603105, Россия,

обл. Нижегородская,

г. Нижний Новгород,


ул. Агрономическая, д. 134,

пом. П1, офис 106

Модель: E318553


Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А




05.2020г.


Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife M

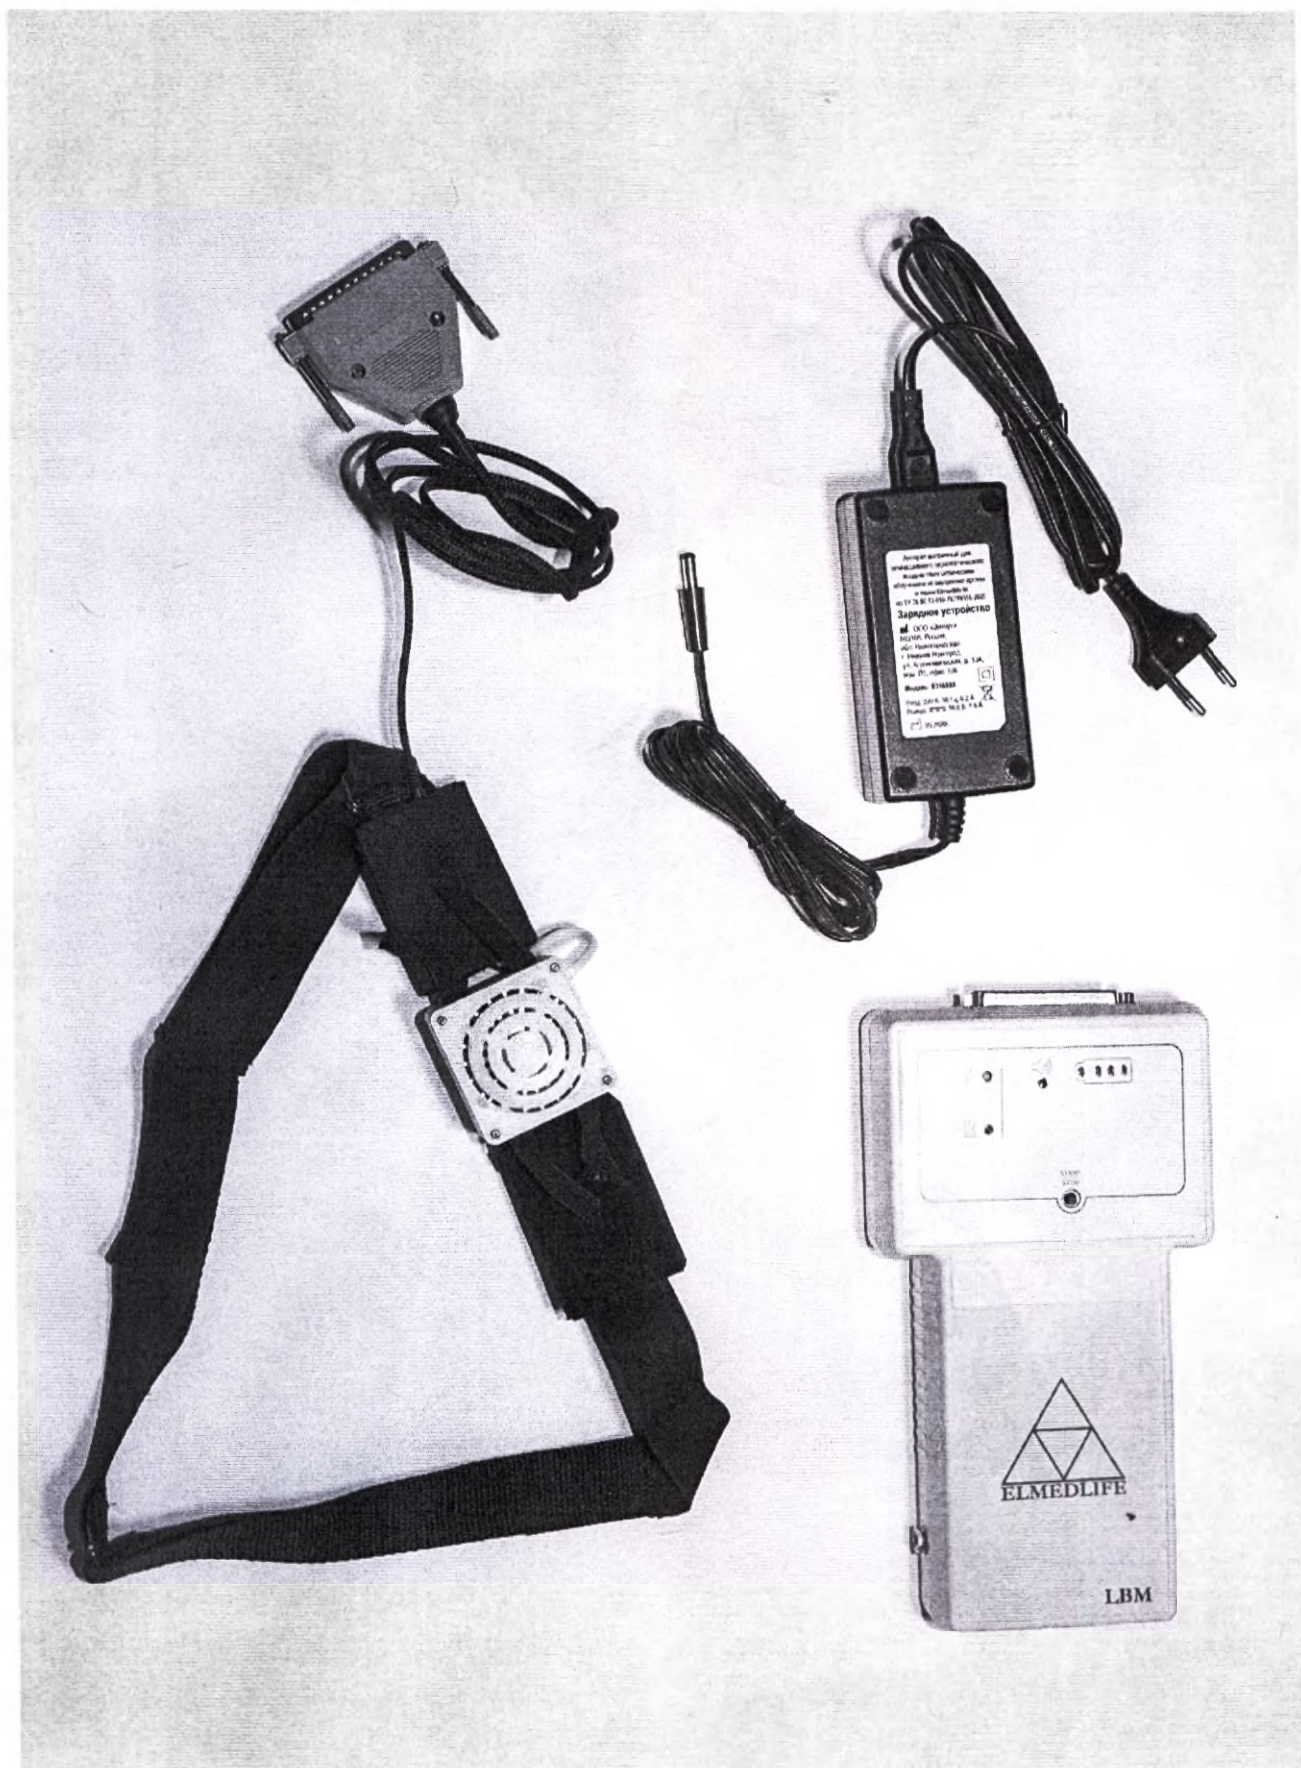


4.1 Моноблок Elmedlife M

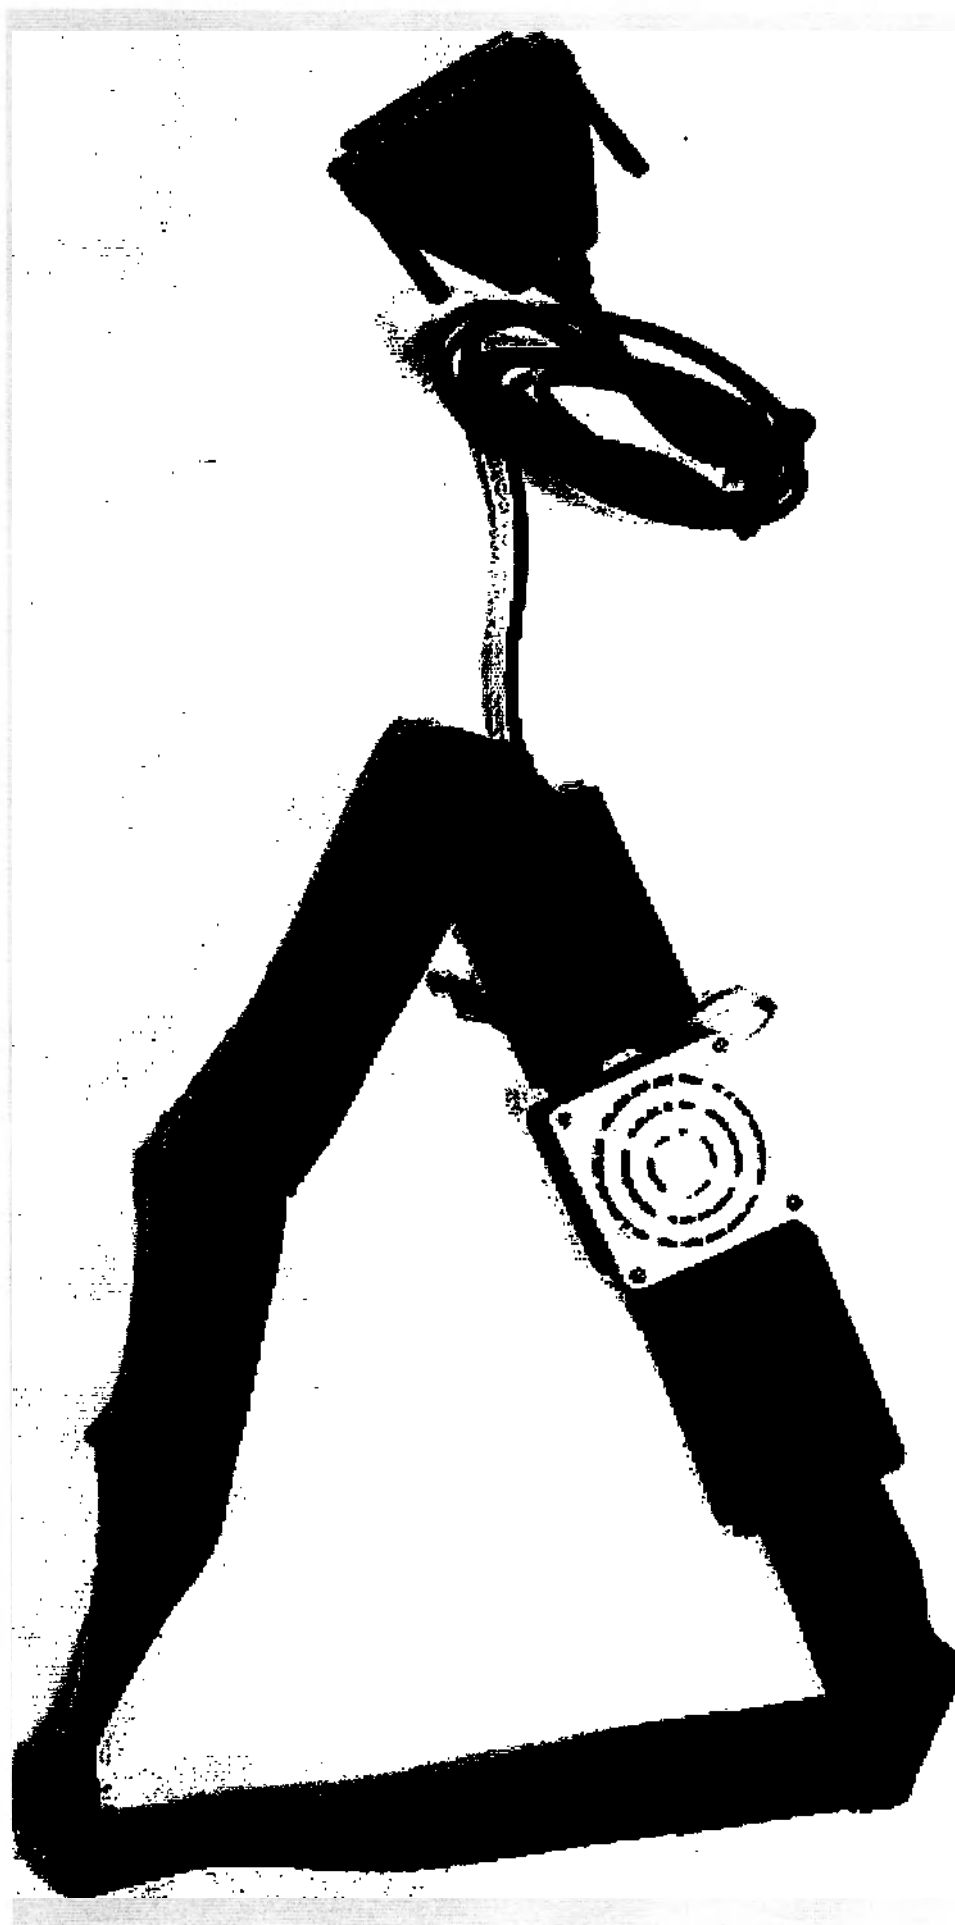

4.2 Блок управления LBM

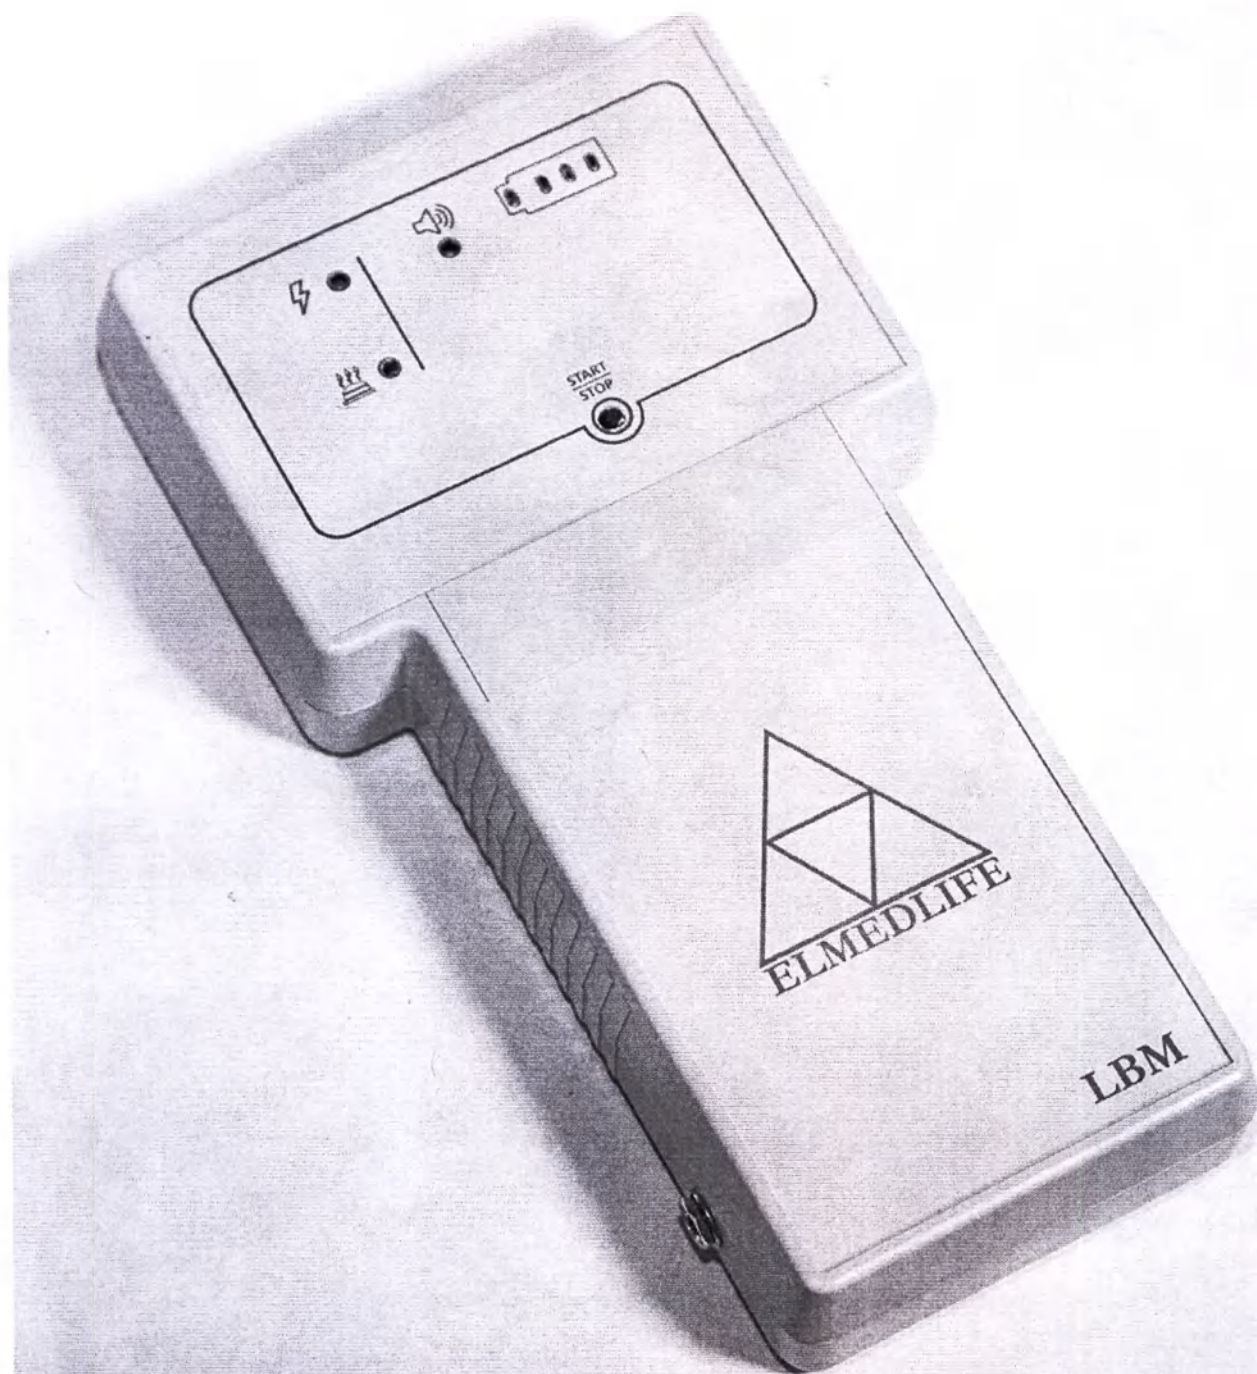

4.3 Зарядное устройство

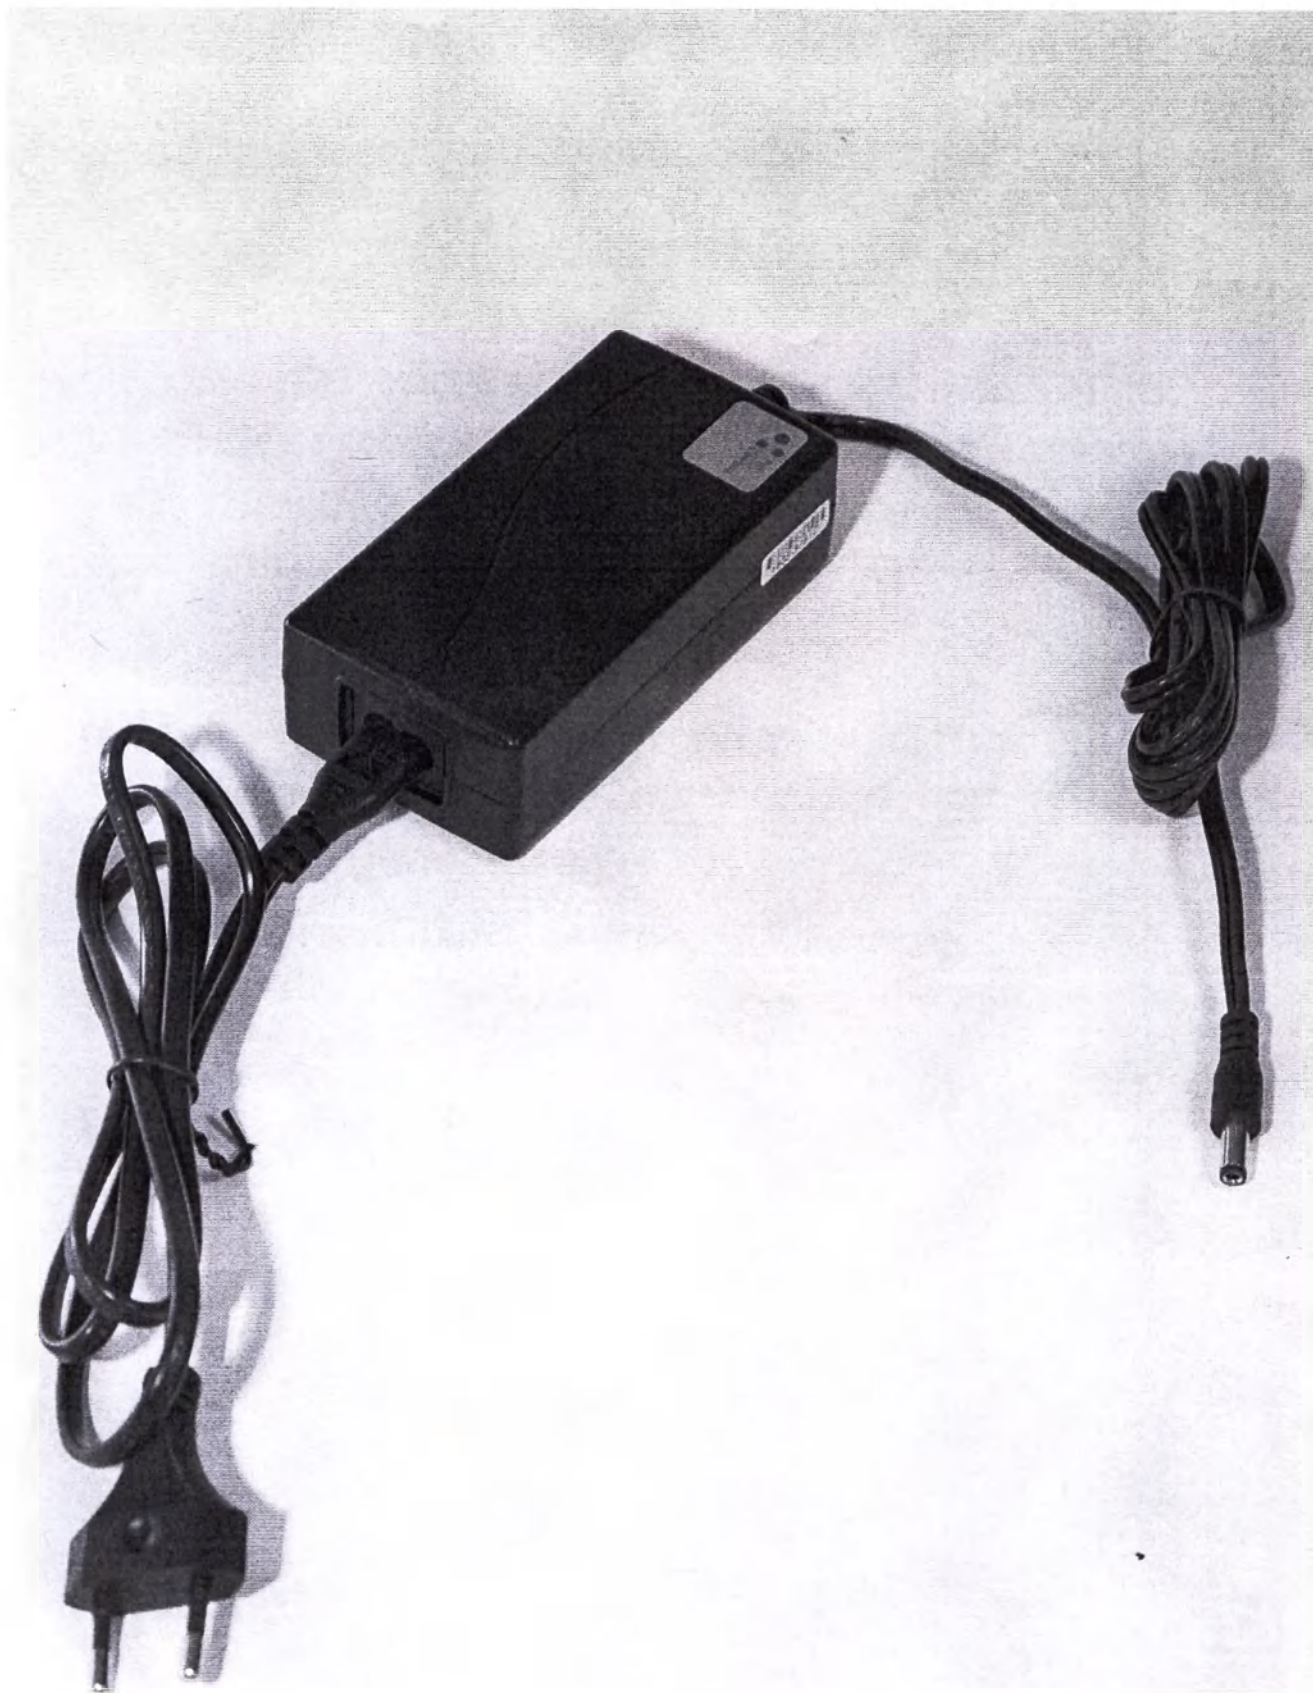

Маркировка на блоке управления LBM Аппарата матричного для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife M

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife M**



ООО «Элторг»


603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0004



IP 20


ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife M
по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020
Зарядное устройство**

 **ООО «Элторг»**
603105, Россия,
обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород,
ул. Агрономическая, д. 134,
пом. П1, офис 106

Модель: E318553

Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А
Выход: === 16.8 В, 1.8 А



05.2020г.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 25 (двадцать) лист(ов)



Генеральный директор

ООО «Элтор»

Гольцман Д.Л.

02 20 21 г

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Элторг»



Гольцман Д.Л.

2020 г.


**АППАРАТ МАТРИЧНЫЙ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ВНУТРЕННИЕ
ОРГАНЫ И ТКАНИ ELMEDLIFE по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020**

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

г. Нижний Новгород

2020


1. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife H

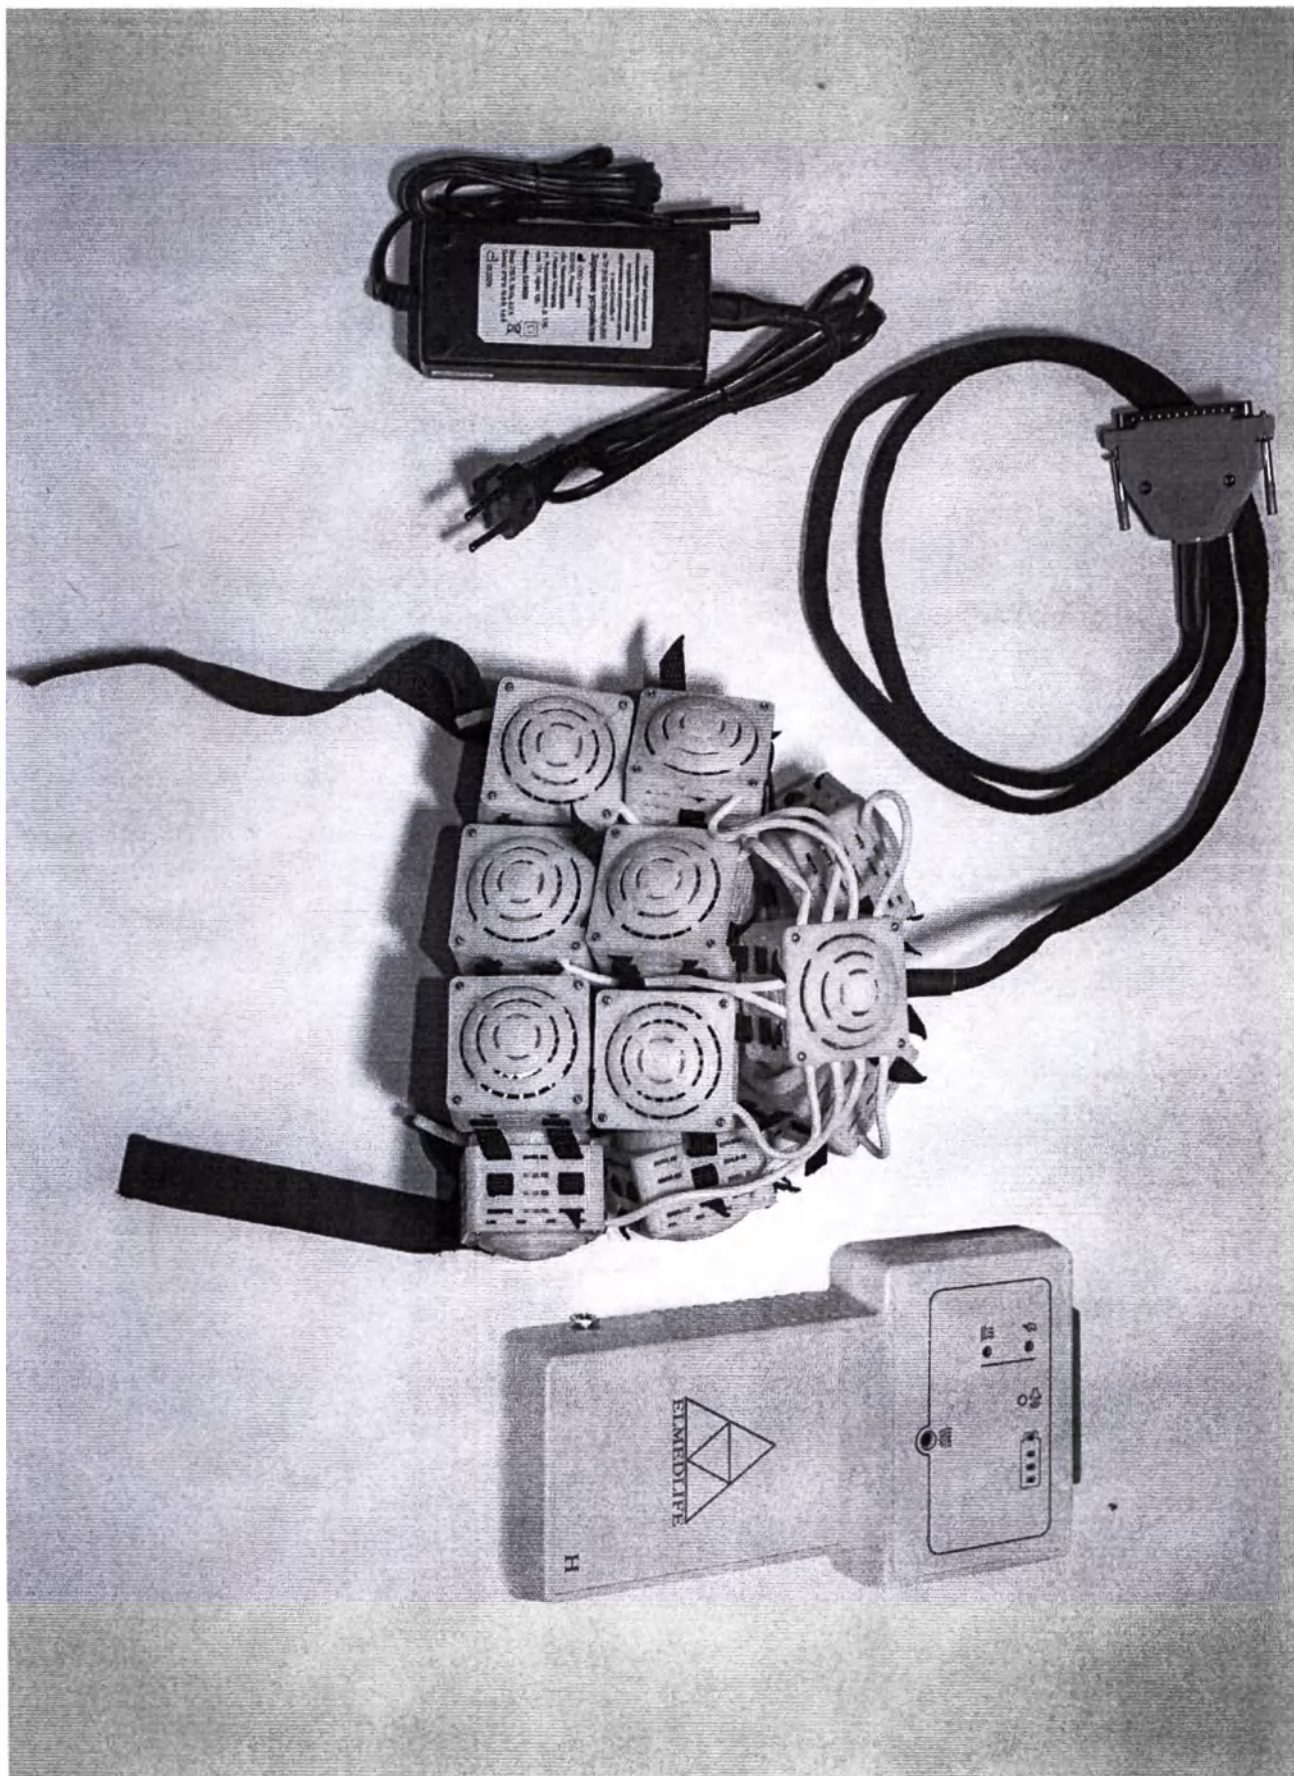

1.1. Шлем-гарнитура Elmedlife H



1.2. Блок управления Н

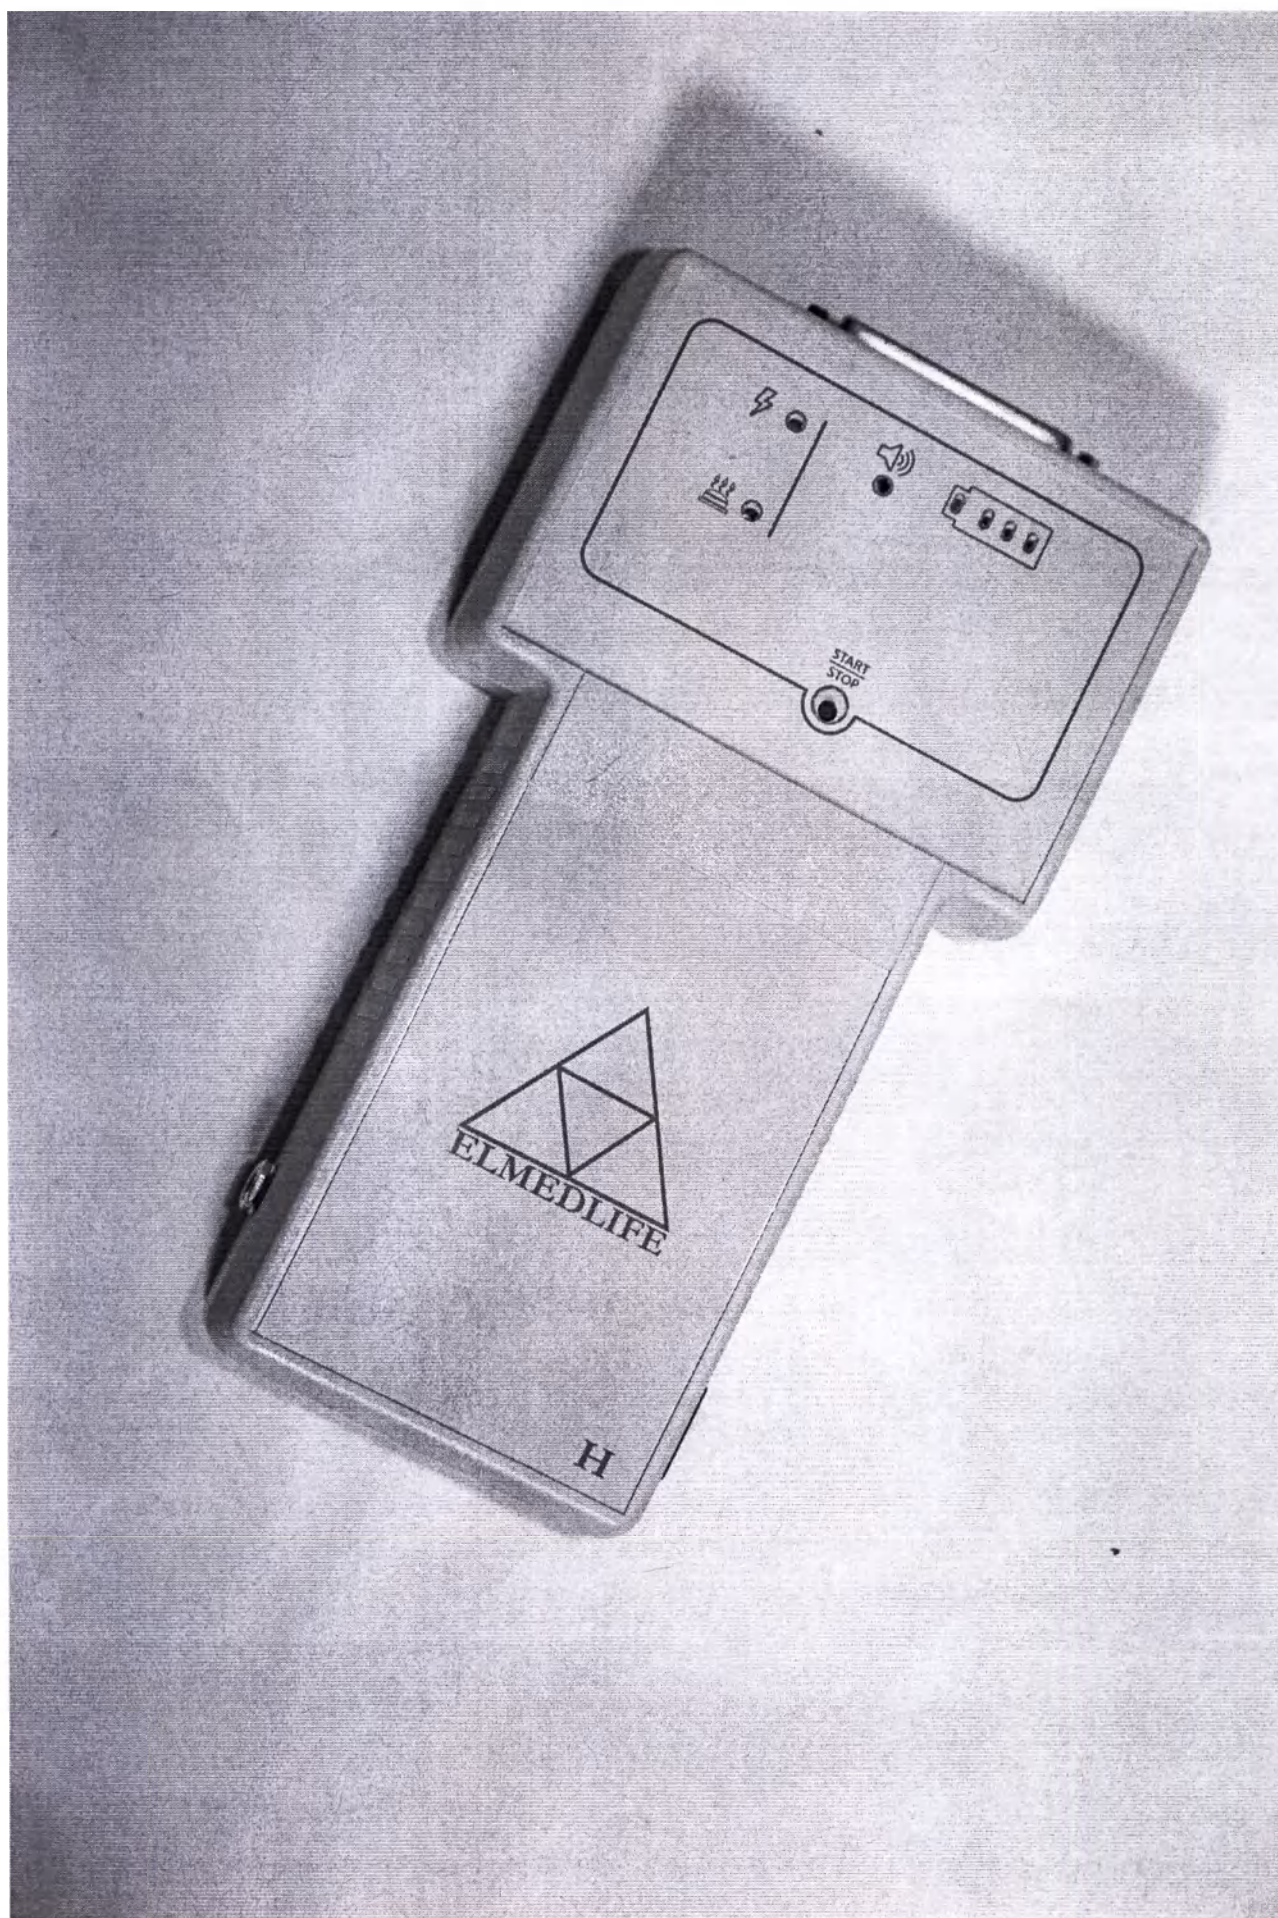

1.3. Зарядное устройство



**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife Н**



ООО «Элторг»

603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0001



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife H
по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020
Зарядное устройство



ООО «Элторг»
603105, Россия,
обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород,
ул. Агрономическая, д. 134,
пом. П1, офис 106


Модель: E318553

Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А


Выход:  16.8 В, 1.8 А




05.2020г.




2. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife L

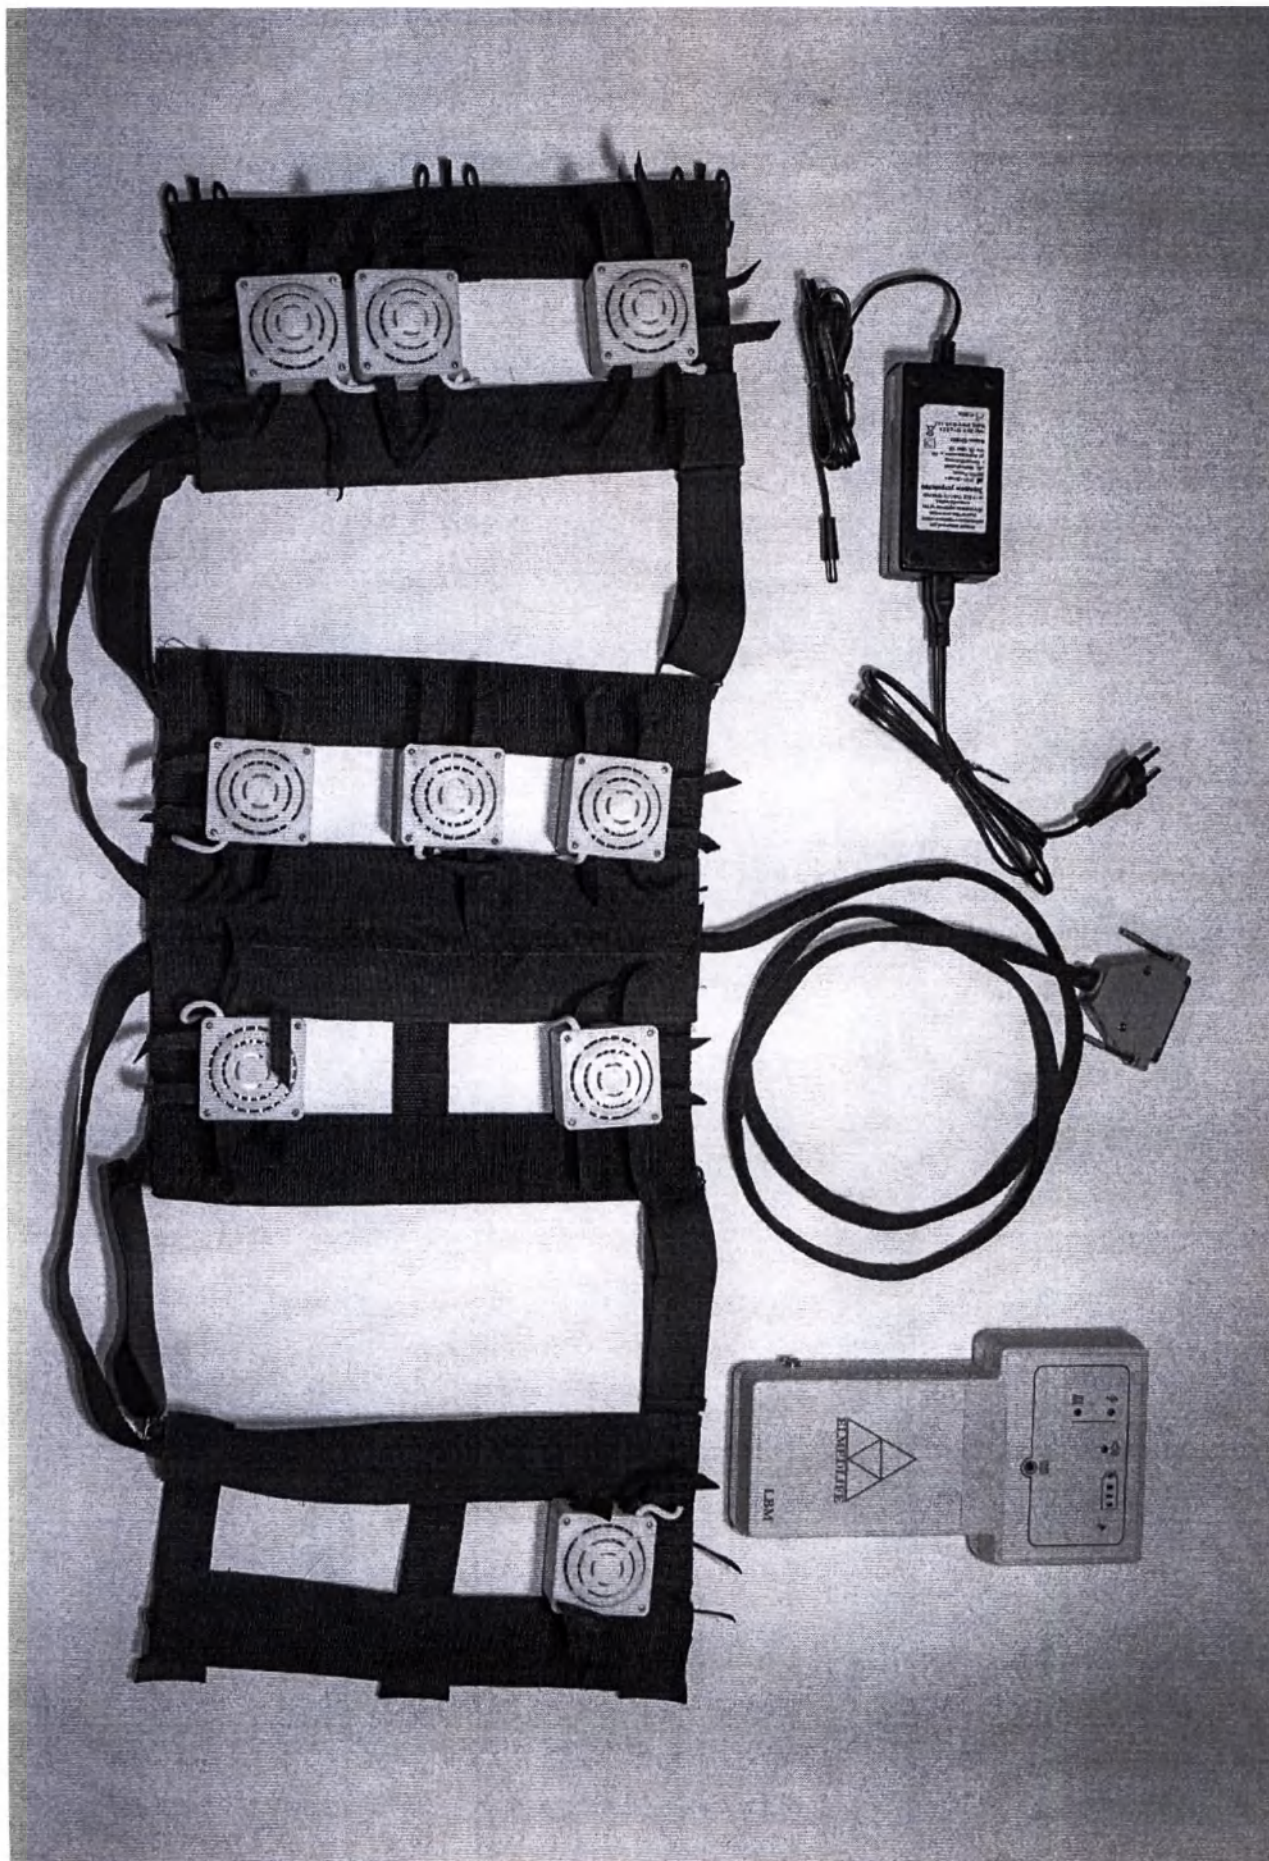

2.1 Жилет-гарнитура Elmedlife L

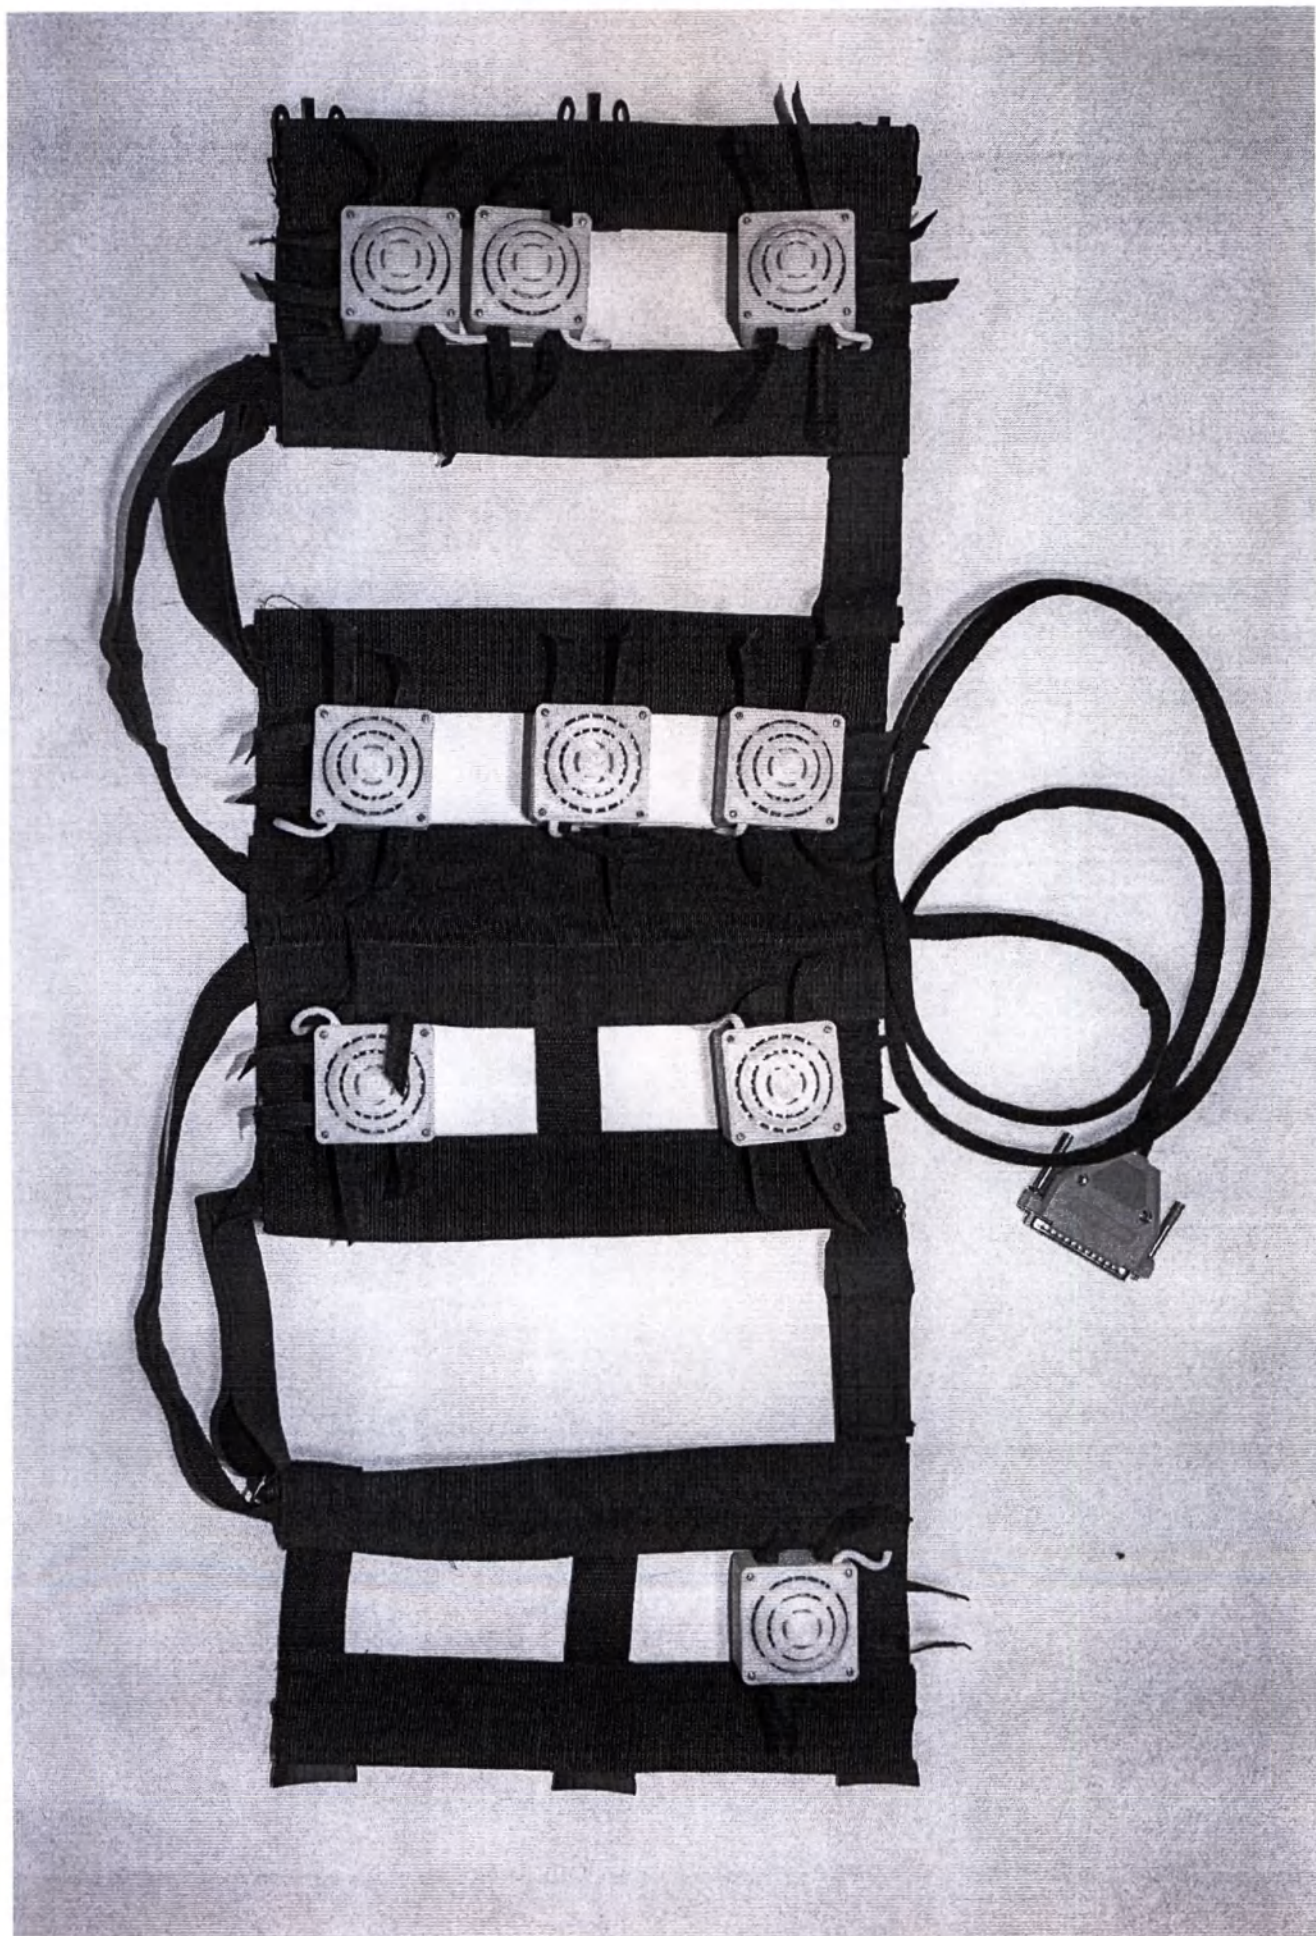

2.2 Блок управления LBM

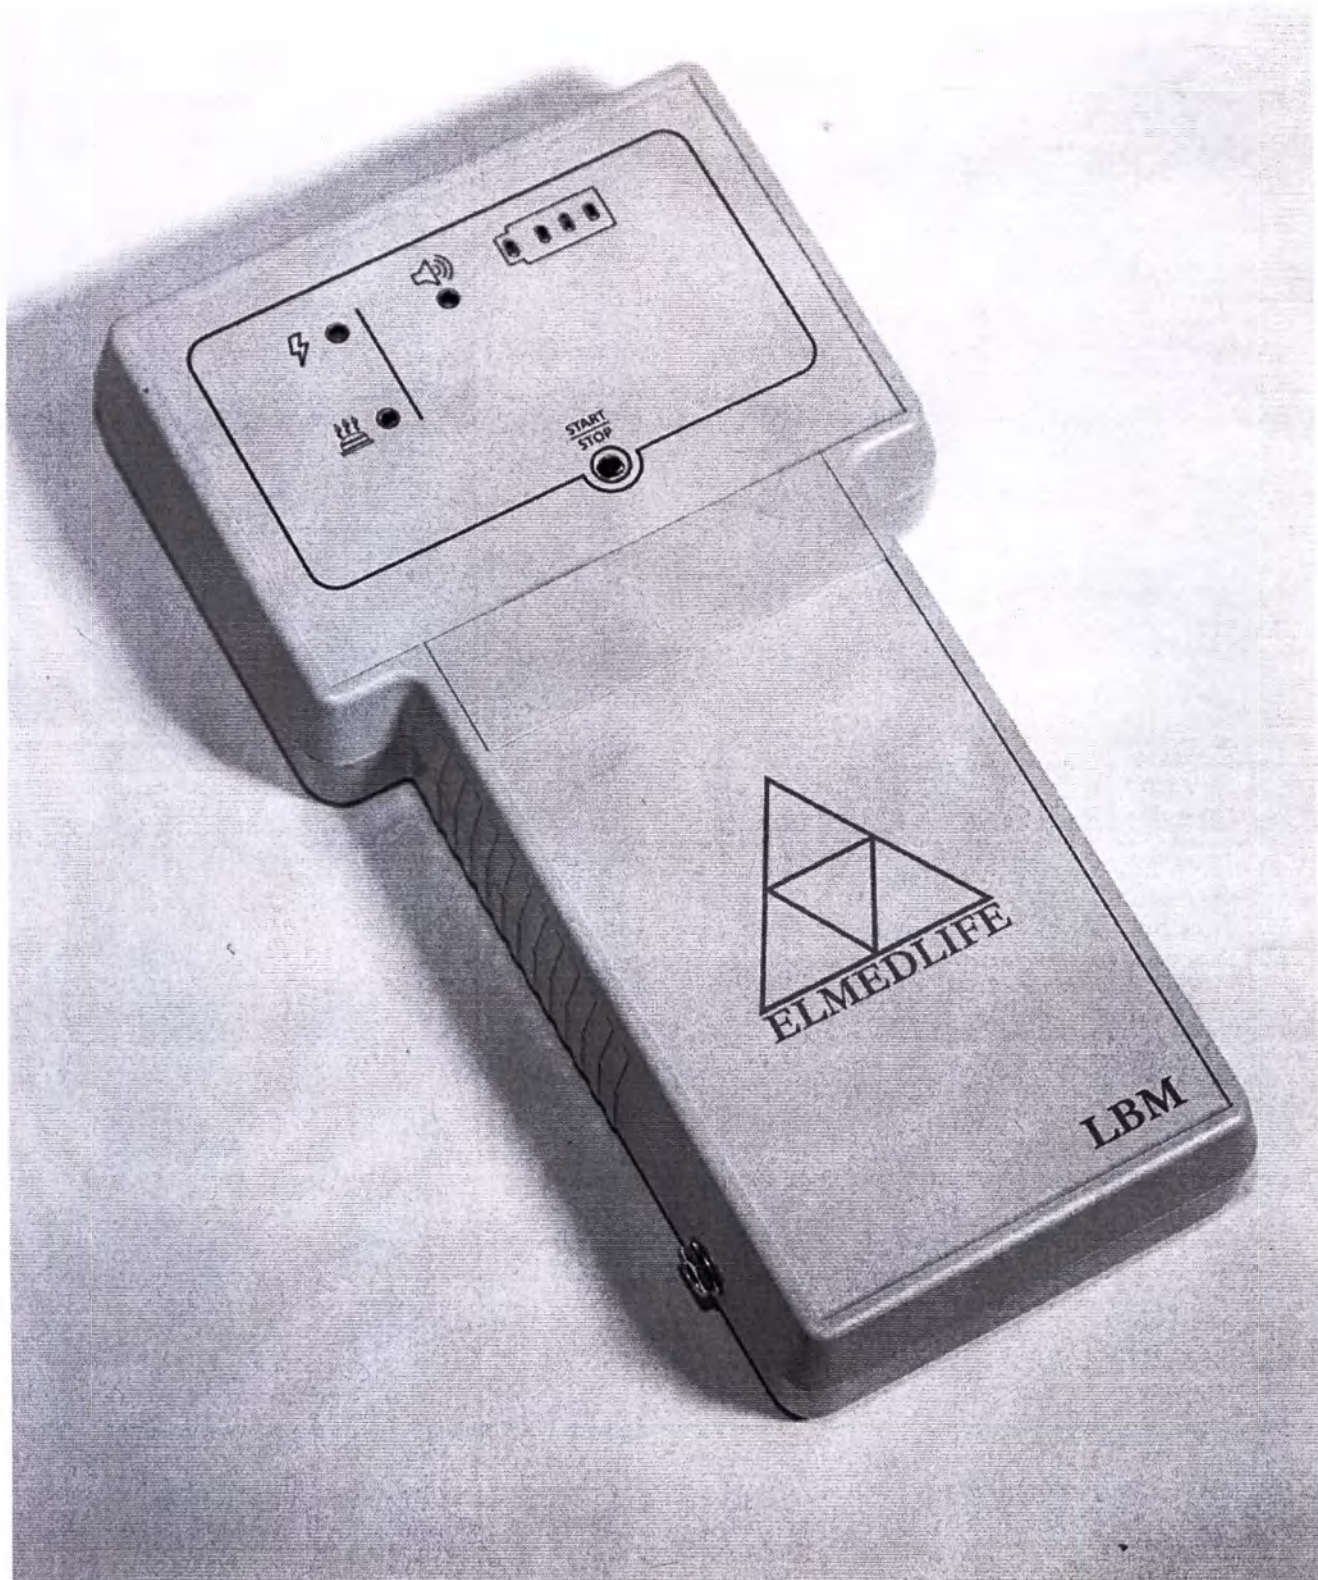

2.3 Зарядное устройство



Маркировка на блоке управления LBM Аппарата матричного для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife L

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife L**



ООО «Элторг»
603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В, 
Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0002



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife L**

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»

603105, Россия,

обл. Нижегородская,

г. Нижний Новгород,


ул. Агрономическая, д. 134,

пом. П1, офис 106

Модель: E318553


Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А




05.2020г.


3. Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife B

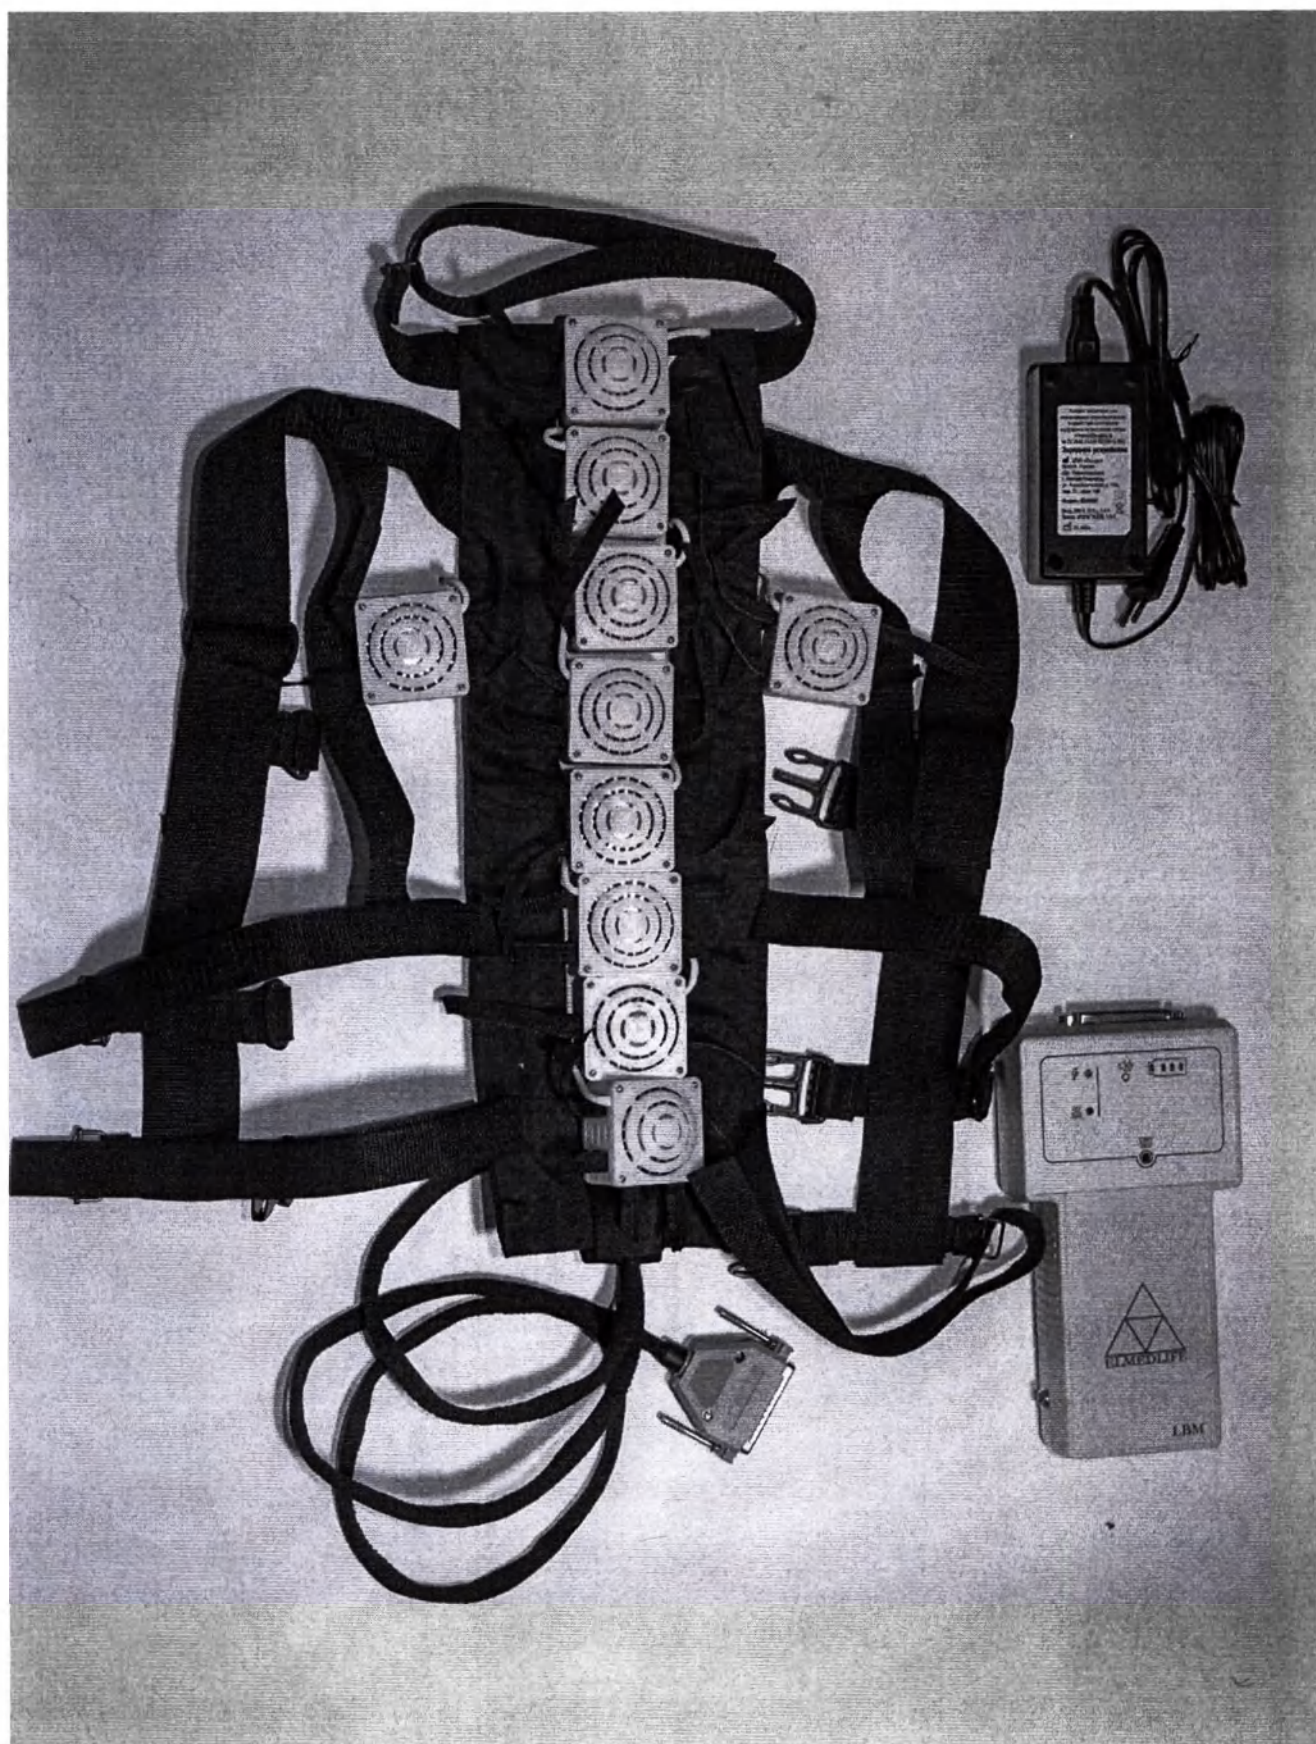


3.1 Жилет-гарнитура Elmedlife B

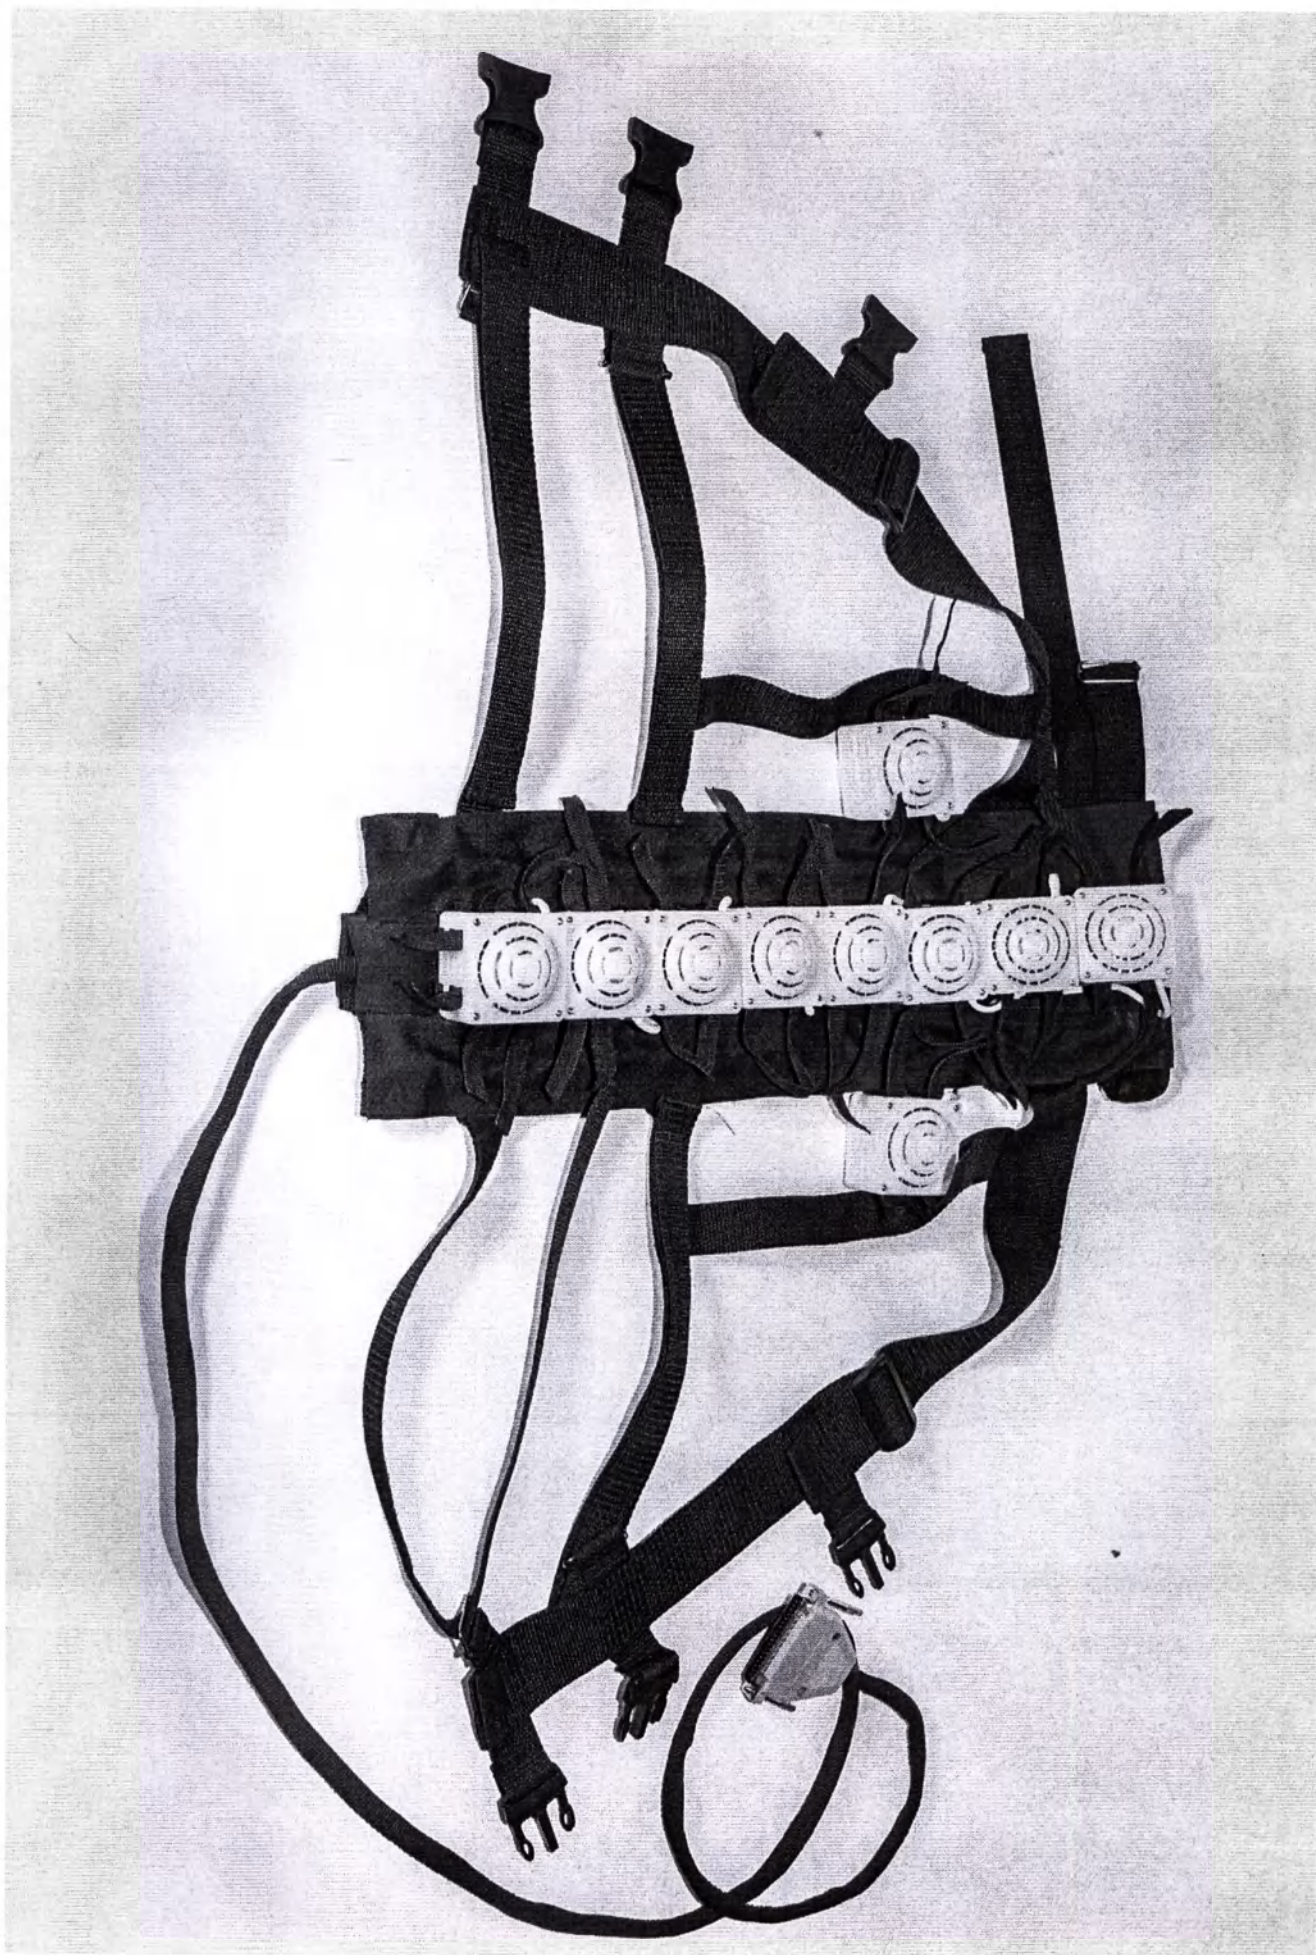

3.2 Блок управления LBM

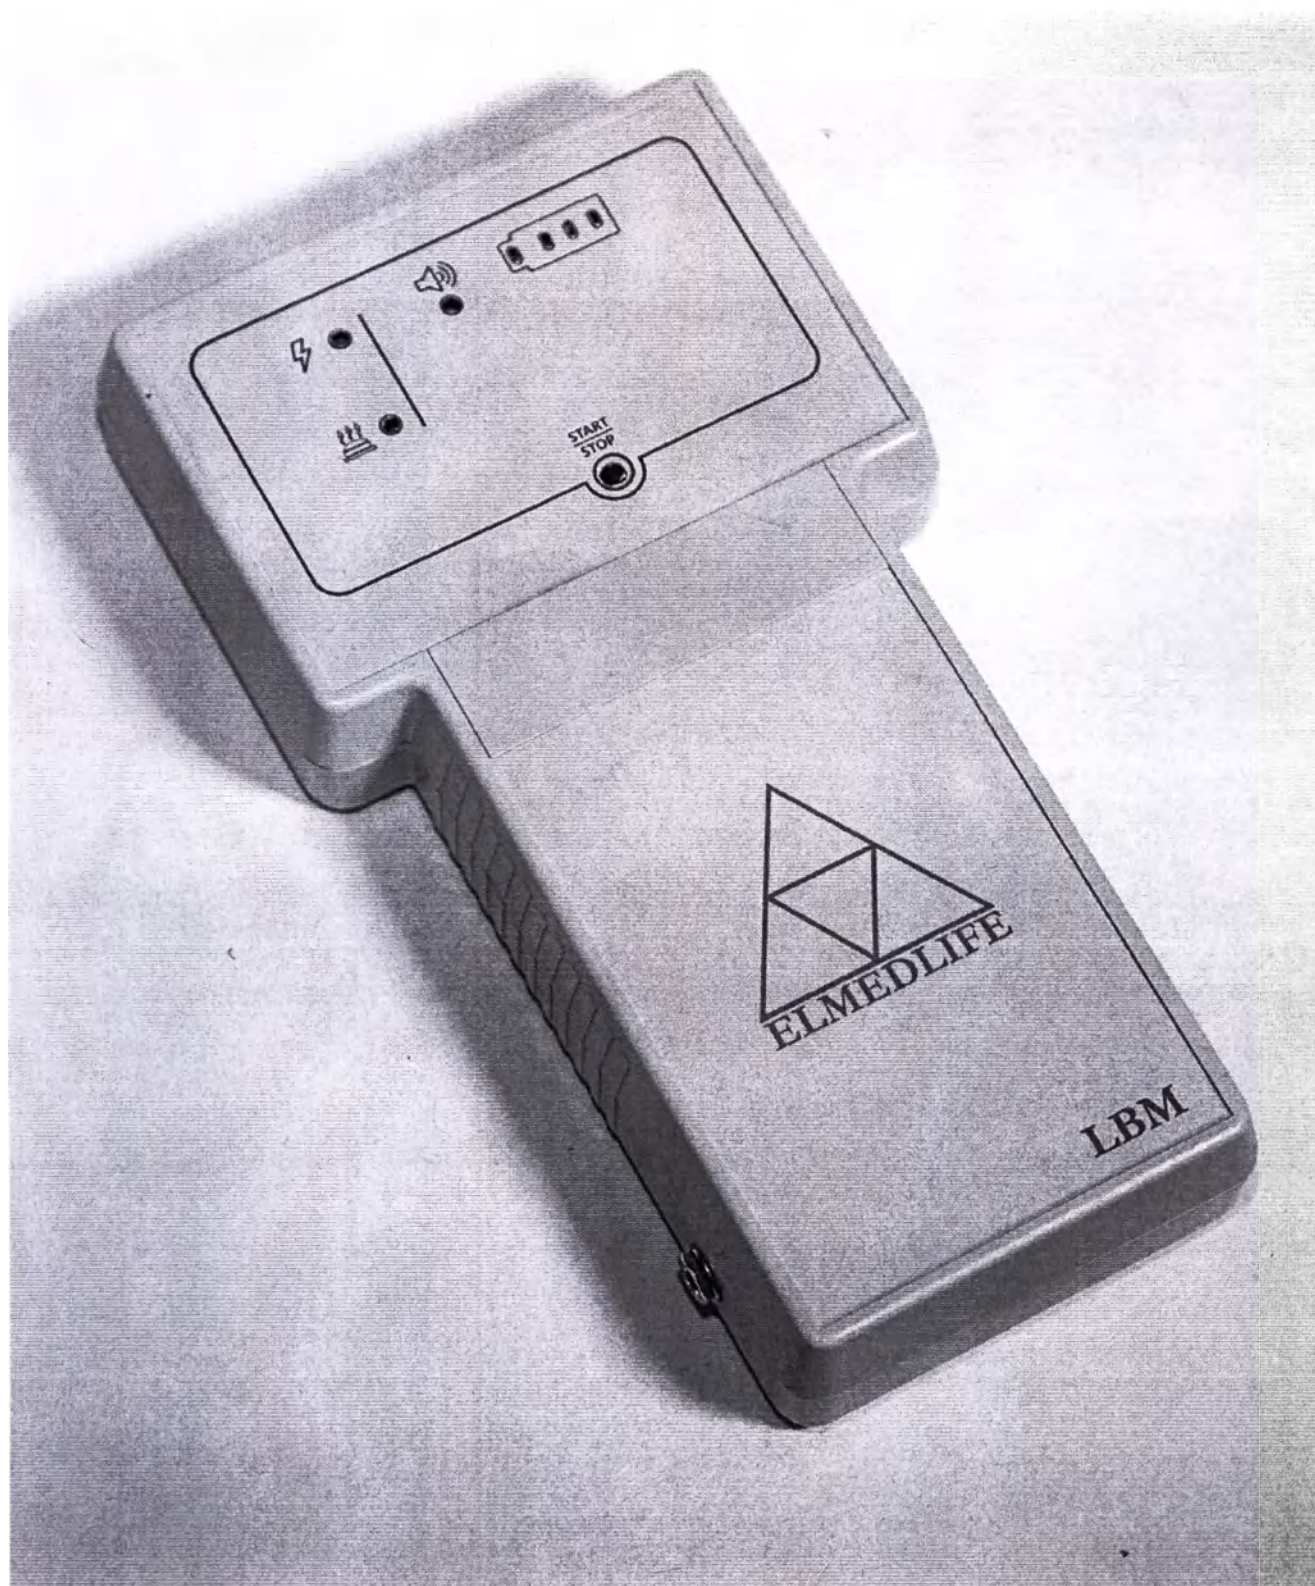

3.3 Зарядное устройство

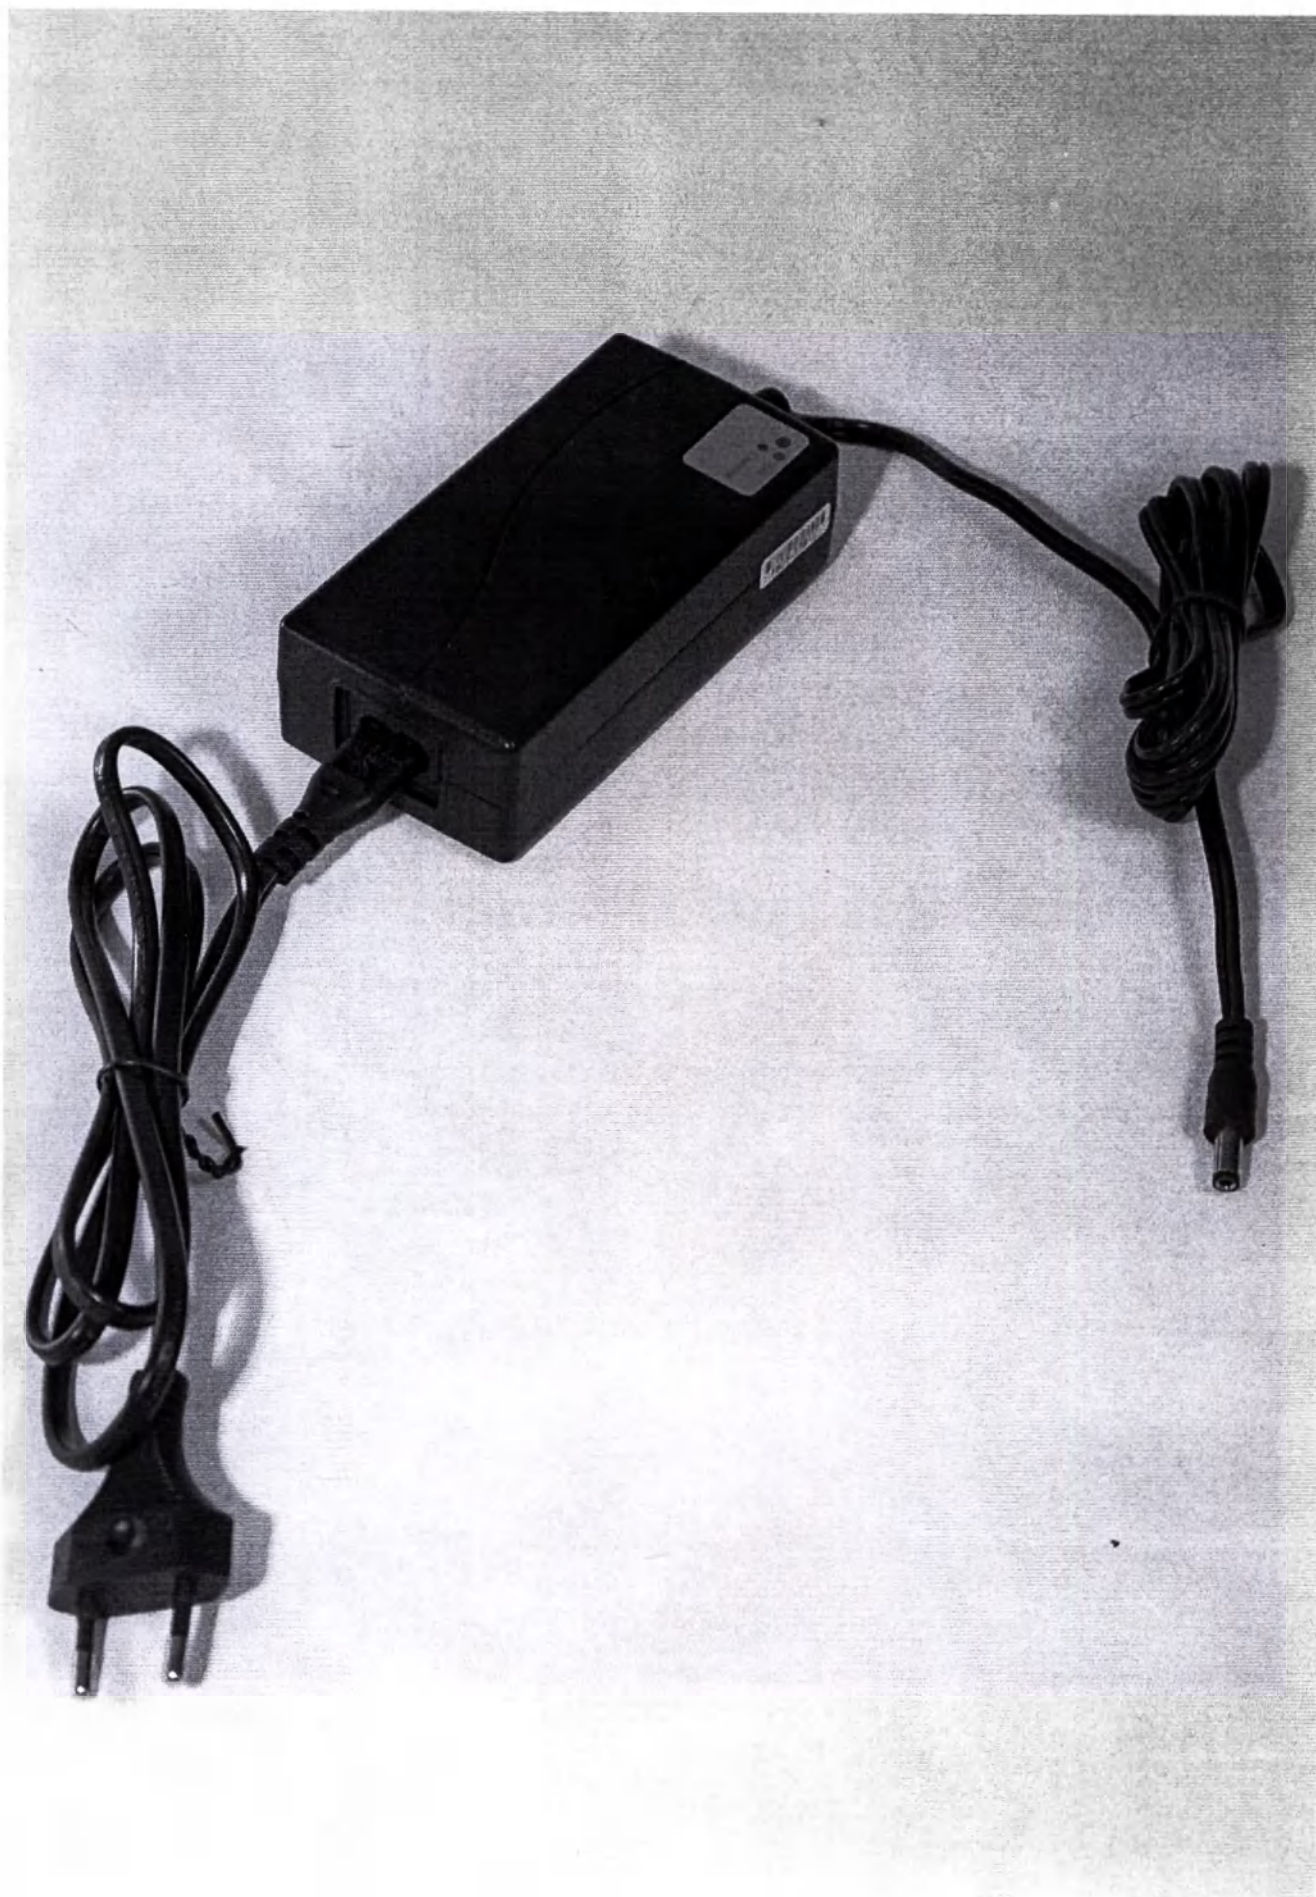

Маркировка на блоке управления LBM Аппарата матричного для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife B

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife B**



ООО «Элторг»

603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В, 

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0003



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

**Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife B**

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»

603105, Россия,

обл. Нижегородская,

г. Нижний Новгород,

ул. Агрономическая, д. 134,

пом. П1, офис 106

Модель: E318553


Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А



05.2020г.


Аппарат матричный для неинвазивного терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани Elmedlife M

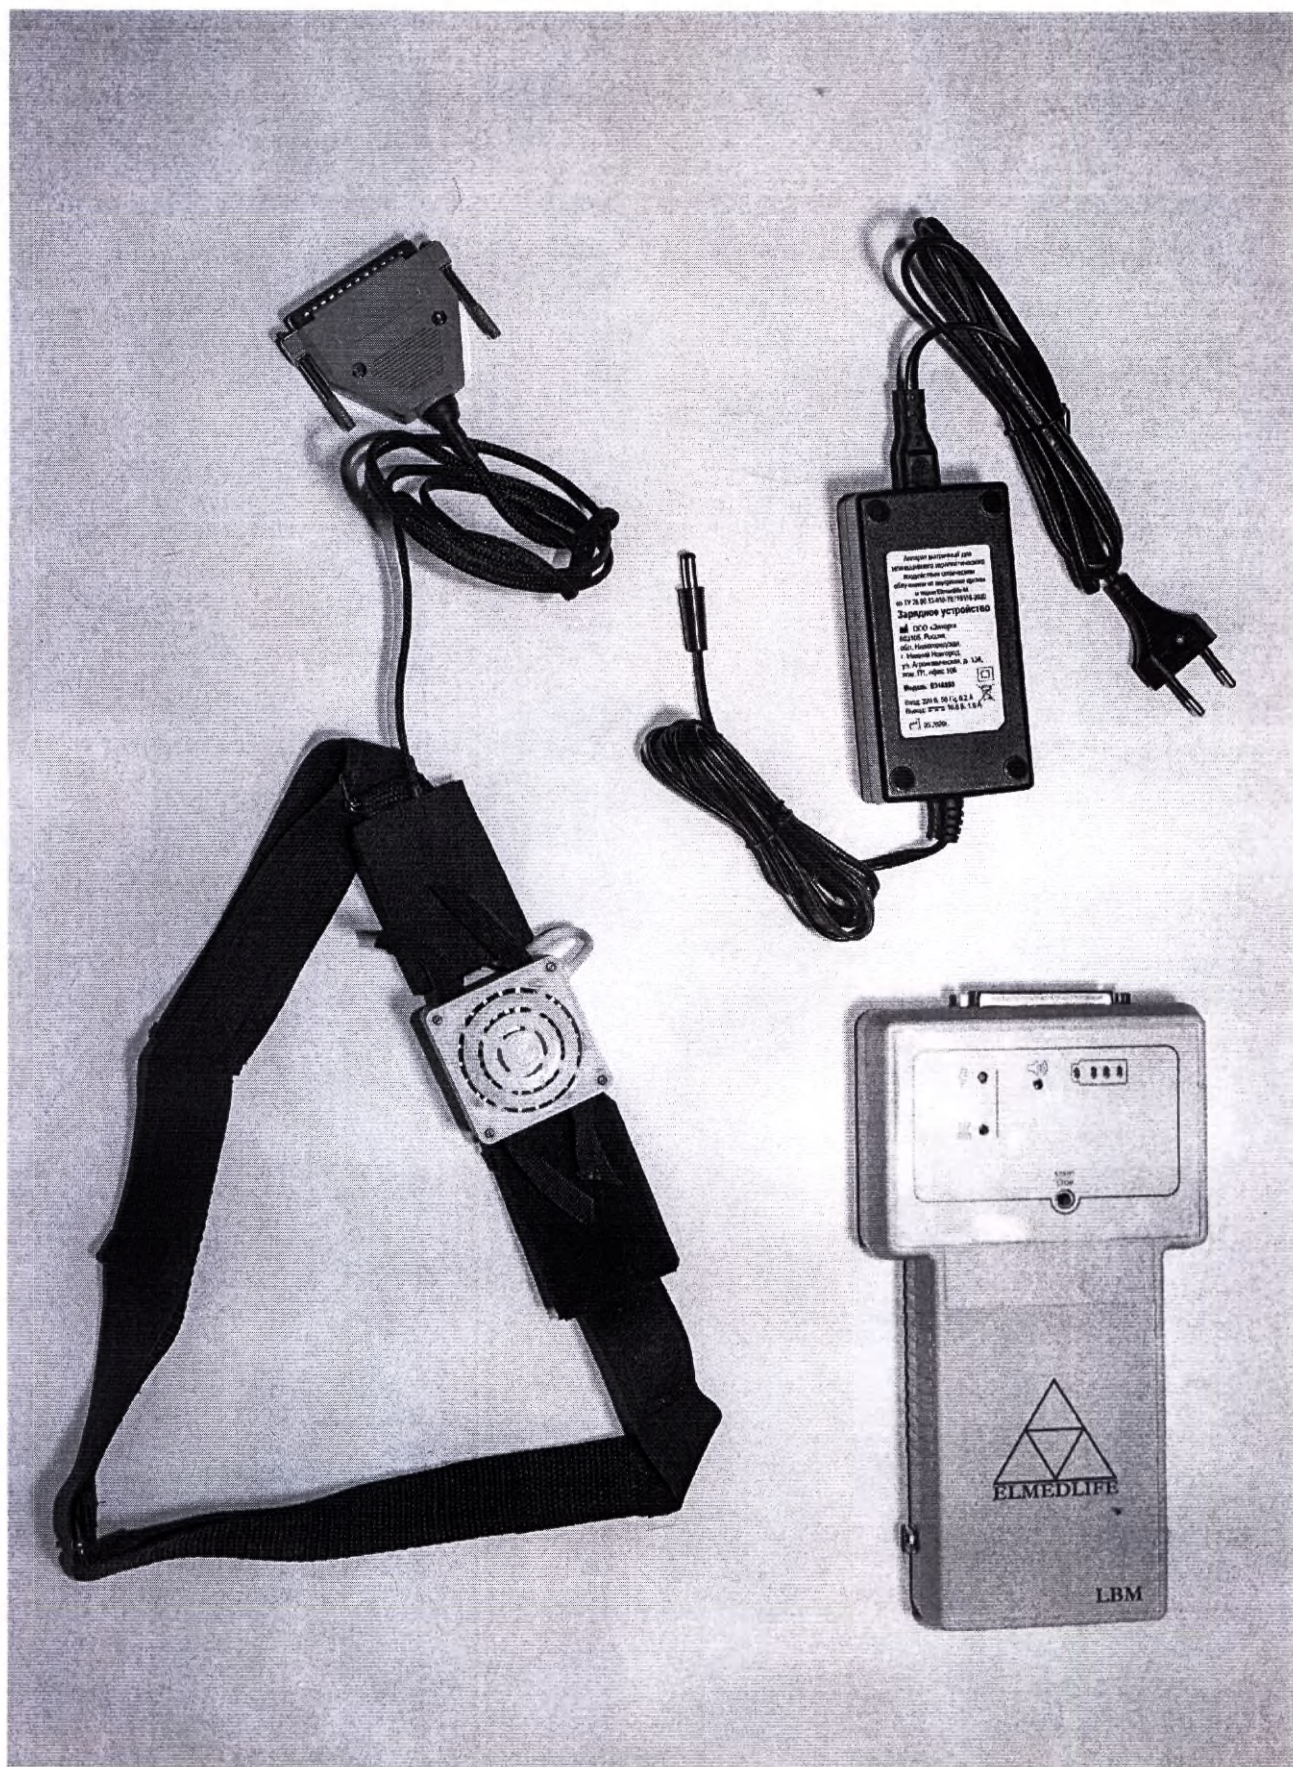


4.1 Моноблок Elmedlife M



4.2 Блок управления LBM

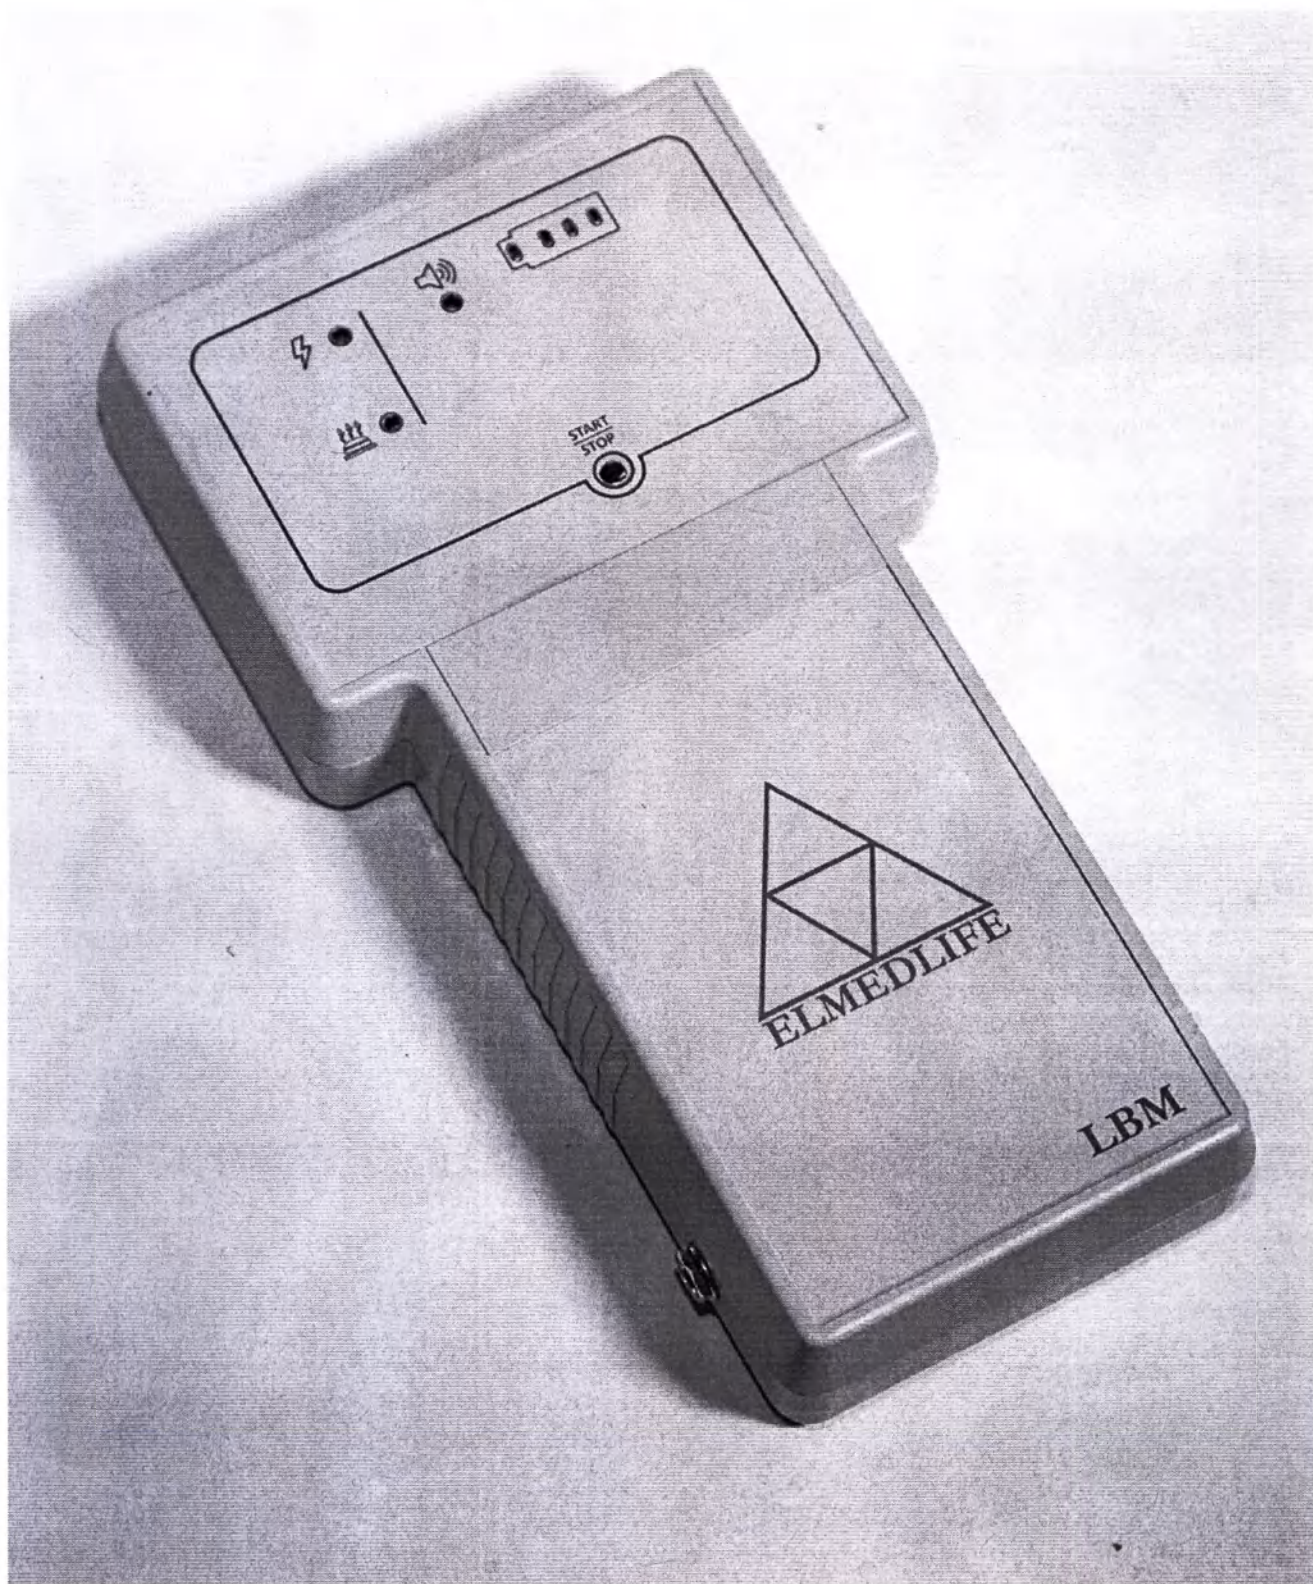

4.3 Зарядное устройство

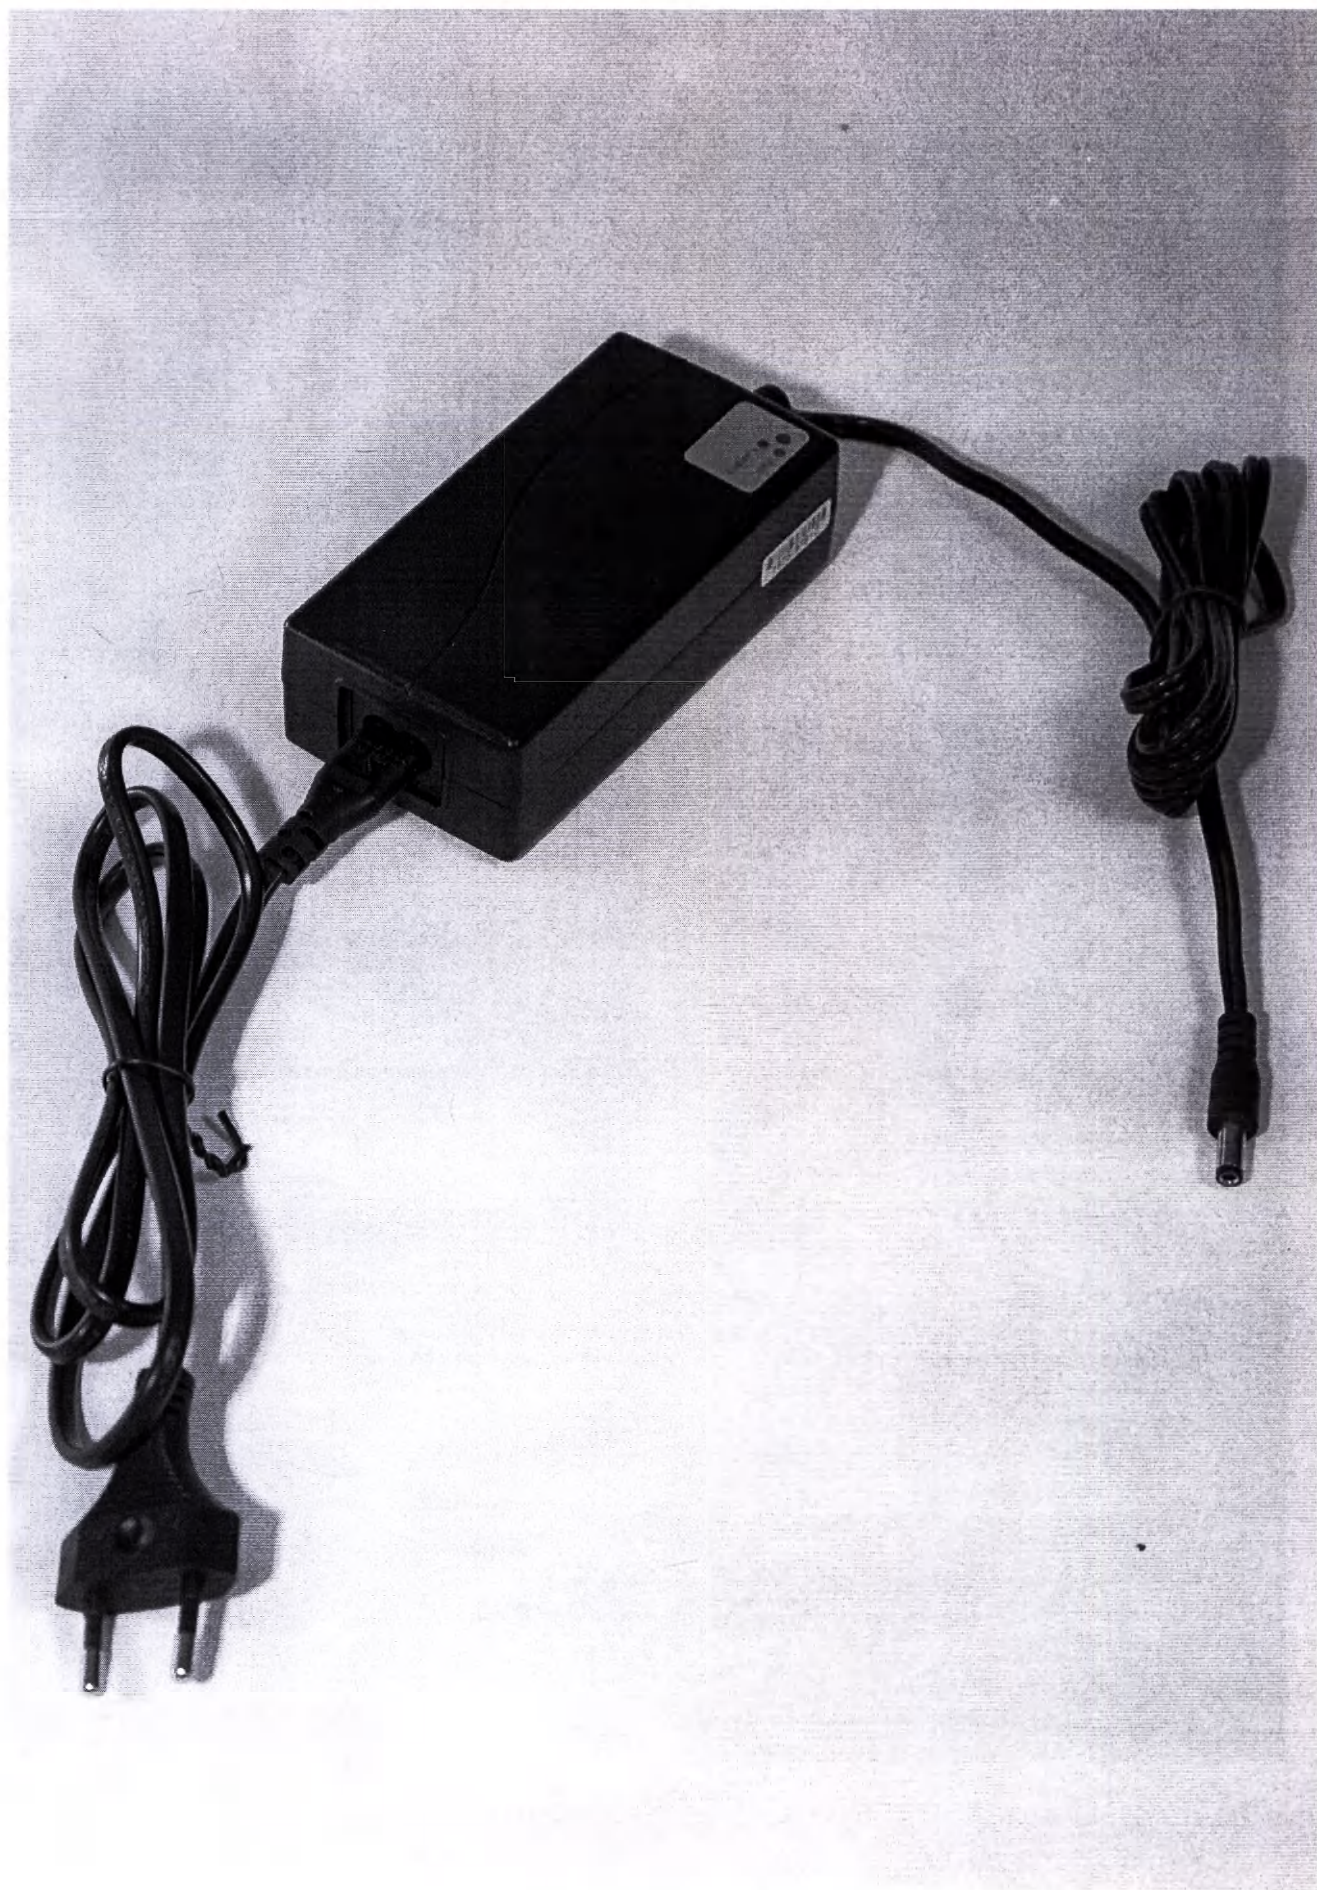

Маркировка на блоке управления LBM Аппарата матричного для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife M

**Аппарат матричный для неинвазивного
терапевтического воздействия оптическим
излучением на внутренние органы и ткани
Elmedlife M**



ООО «Элторг»


603105, Россия, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, ул. Агрономическая, д. 134, пом. П1,
офис 106

Напряжение источника питания: 16,8 В,

Макс. рабочий цикл: 15 мин – работа, 15 мин – пауза



05.2020 г.



0004



IP 20

ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Аппарат матричный для
неинвазивного терапевтического
воздействия оптическим
излучением на внутренние органы
и ткани Elmedlife M

по ТУ 26.60.13-010-78719318-2020

Зарядное устройство



ООО «Элторг»

603105, Россия,

обл. Нижегородская,

г. Нижний Новгород,



ул. Агрономическая, д. 134,

пом. П1, офис 106

Модель: E318553

Вход: 220 В, 50 Гц, 0.2 А

Выход:  16.8 В, 1.8 А



05.2020г.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 25 (двадцать пять) лист(ов)

Генеральный директор



Гольцман Д.Л.

11 20 20 г