



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «МЕДИЭЙС»
Викторов Н.В.

30 августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ И МАКЕТОВ РУССКОЯЗЫЧНОЙ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Система диагностическая ультразвуковая HS40-RUS с принадлежностями



Упаковка системы диагностической ультразвуковой HS40-RUS с принадлежностями



Пример упаковки датчиков

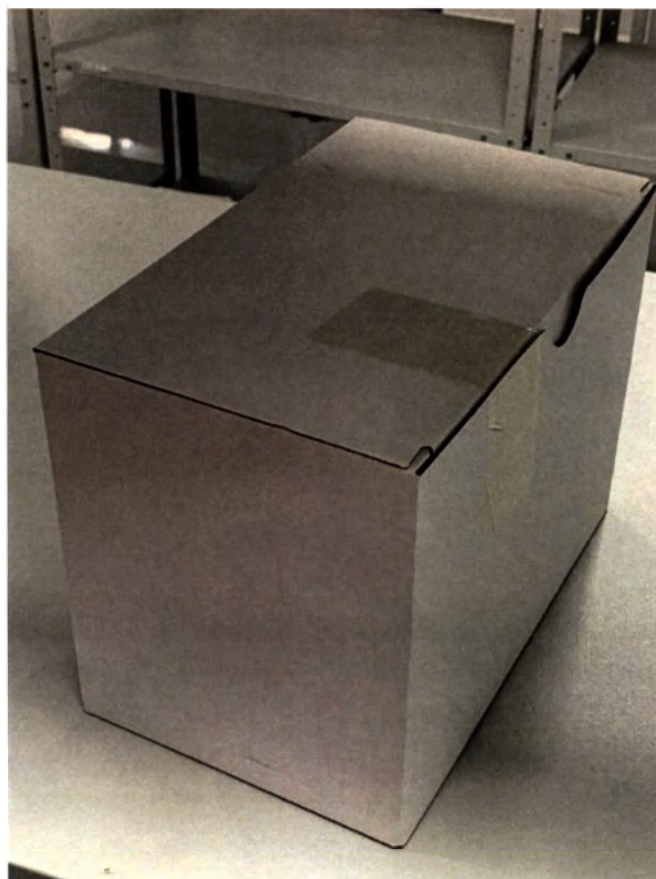


Пример упаковки набора для биопсии



Пример упаковки насадки для биопсии для моделей комплектов: ВР-КИТ-054, ВР-КИТ-068, ВР-КИТ-055, ВР-КИТ-049



Пример упаковки стерильных иглопроводников/креплений иглопроводников для моделей комплектов: ВР-КИТ-054, ВР-КИТ-068, ВР-КИТ-055, ВР-КИТ-049

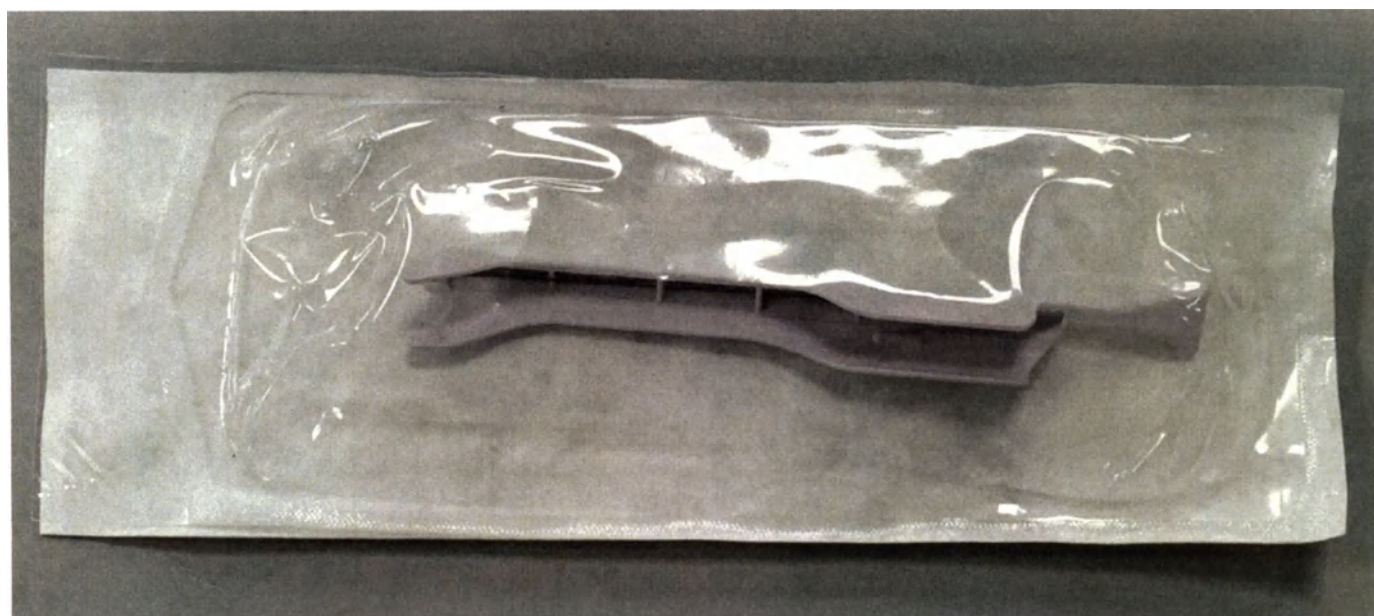

Пример упаковки стерильных иглопроводников для моделей комплектов: ВР-КИТ-061 и ВР-КИТ-060



Пример упаковки иглопроводников для моделей комплектов: ВР-КИТ-024 и ВР-КИТ-029



Макет маркировки Системы диагностической ультразвуковой HS40-RUS

Датчик для ультразвуковых диагностических систем производства SAMSUNG MEDISON, вариант исполнения: Датчик фазированный PA1-5A



SAMSUNG MEDISON CO., LTD. (САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do
25108, Republic of Korea

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «МЕДИЭЙС» 127422, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел: +7 (495) 150-38-30 Web: www.medison.ru E-mail: info@medison.ru

SN MI68-000000

Rx ONLY



CE 0123 IPX7



01.01.2023 г.

Регистрационное удостоверение № PЗН 2020/10698

Макет русскоязычной маркировки датчиков на примере датчика
фазированного PA1-5A

Набор для биопсии:

- иглопроводник – 1шт.



Protek Medical Product Inc.

20 Ga

Для Системы диагностической ультразвуковой HS40-RUS с принадлежностями
производства **SAMSUNG MEDISON CO., LTD. (САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)**
3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108, Republic of
Korea

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «МЕДИЭЙС» 127422, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел: +7 (495) 150-38-30 Web: www.medison.ru E-mail: info@medison.ru

LOT

77511


REF

4020

STERILE EO



0470



03.02.2023

02.02.2026

Регистрационное удостоверение № PЗН 2019/8227

Макет русскоязычной маркировки стерильных иглопроводников/креплений
иглопроводников для моделей комплектов: BP-KIT-054, BP-KIT-068, BP-KIT-055, BP-
KIT-049

Набор для биопсии:

- насадка для биопсии – 1шт.



Protek Medical Product Inc.

Для Системы диагностической ультразвуковой HS40-RUS с
принадлежностями производства **SAMSUNG MEDISON CO., LTD.**
(САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108,
Republic of Korea

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «МЕДИЭЙС» 127422, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел: +7 (495) 150-38-30 Web: www.medison.ru E-mail: info@medison.ru

LOT


22546

REF

BP-KIT-049



0470



03.02.2023

02.02.2026

Регистрационное удостоверение № PЗН 2019/8227

Макет русскоязычной маркировки насадок для биопсии для моделей комплектов: BP-
KIT-054, BP-KIT-068, BP-KIT-055, BP-KIT-049

Набор для биопсии:

- иглопроводник – 1шт.



Protek Medical Product Inc.

16 Ga

Для Системы диагностической ультразвуковой HS40-RUS с
принадлежностями производства SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
(САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108,
Republic of Korea

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «МЕДИЭЙС» 127422, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3

Тел: +7 (495) 150-38-30

Web: www.medison.ru

E-mail: info@medison.ru

LOT

22546

REF

BP-KIT-024



03.02.2023



02.02.2026



R Only



0470

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8227

Макет русскоязычной маркировки иглопроводников для моделей комплектов: BP-KIT-024 и BP-KIT-029



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью. 5 листов

Генеральный директор
ЗАО «Медиэкс»

Н.В. Викторов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «МЕДИЙС»

Викторов Н.В.

« ____ » _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система диагностическая ультразвуковая HS40-RUS с принадлежностями




1. Консоль электронная, 2. Панель управления, 3. Специальный LED монитор, 4. Панель сенсорная.




Кабель сетевой



Держатель датчиков

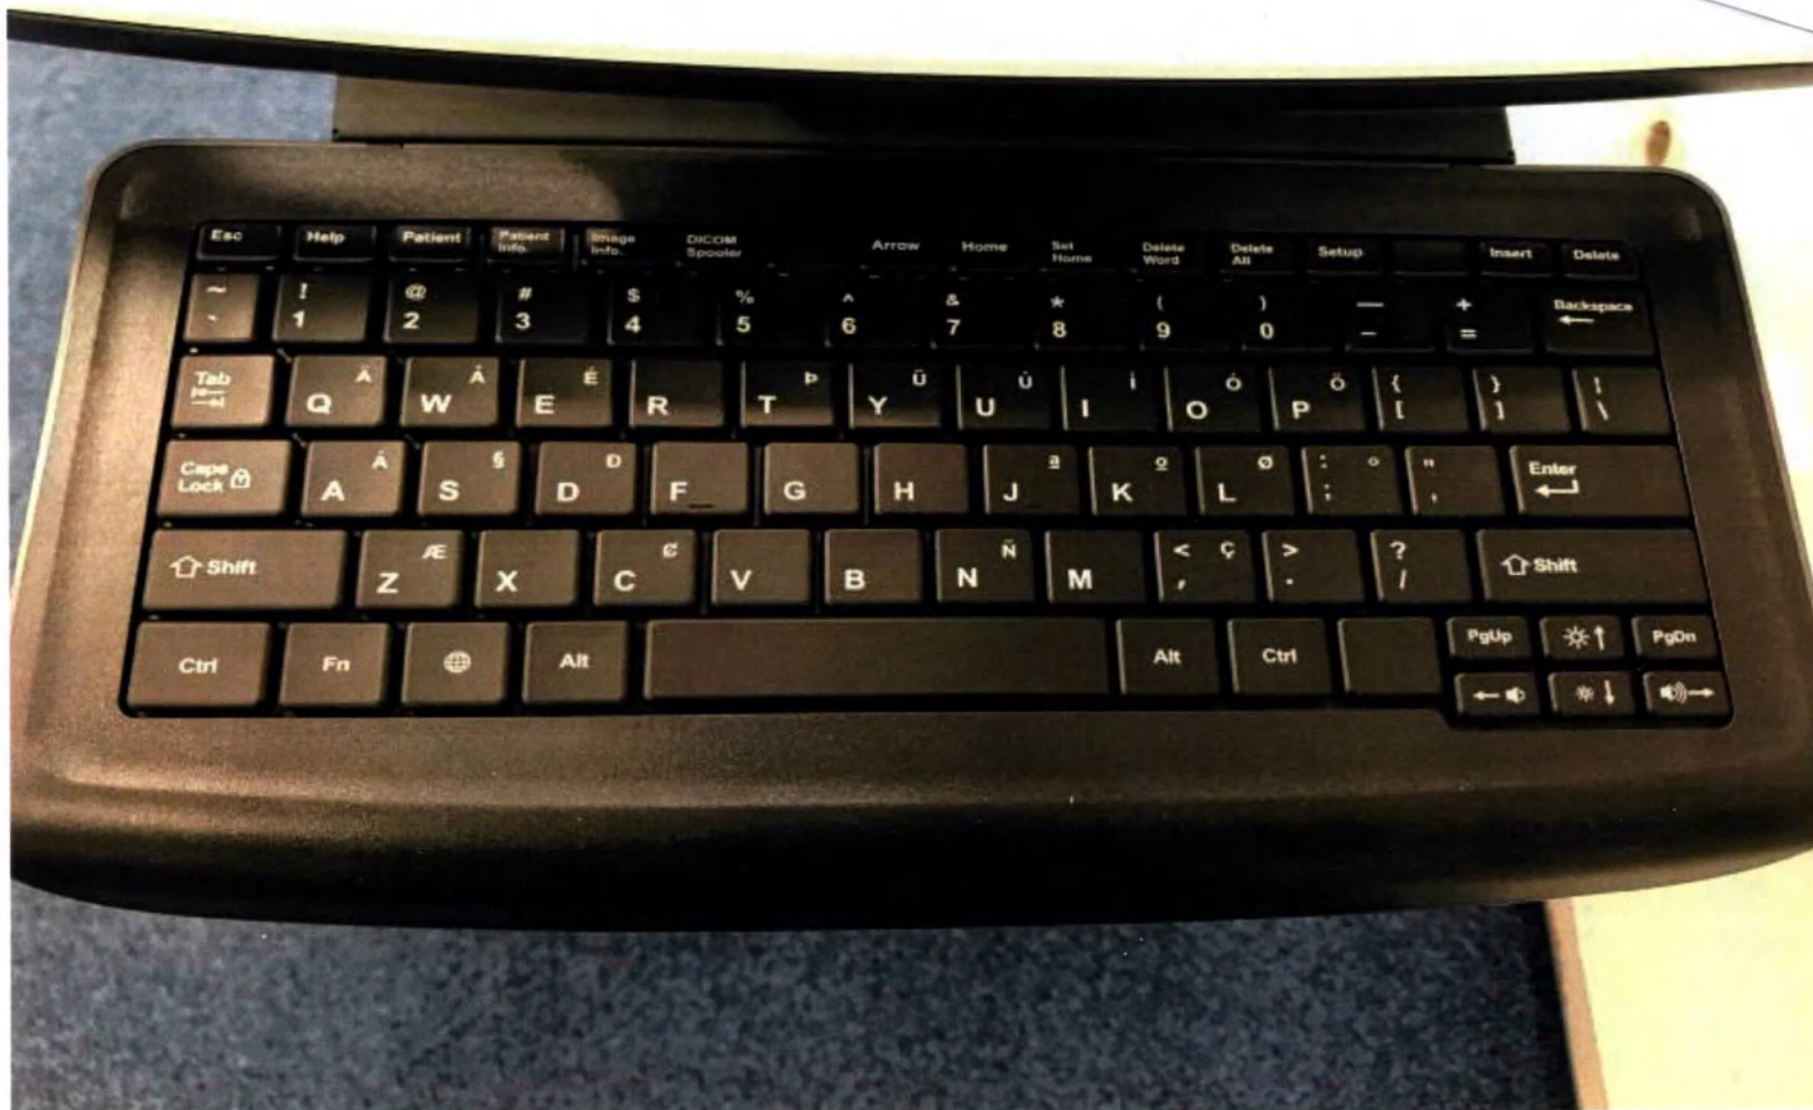


Клавиатура

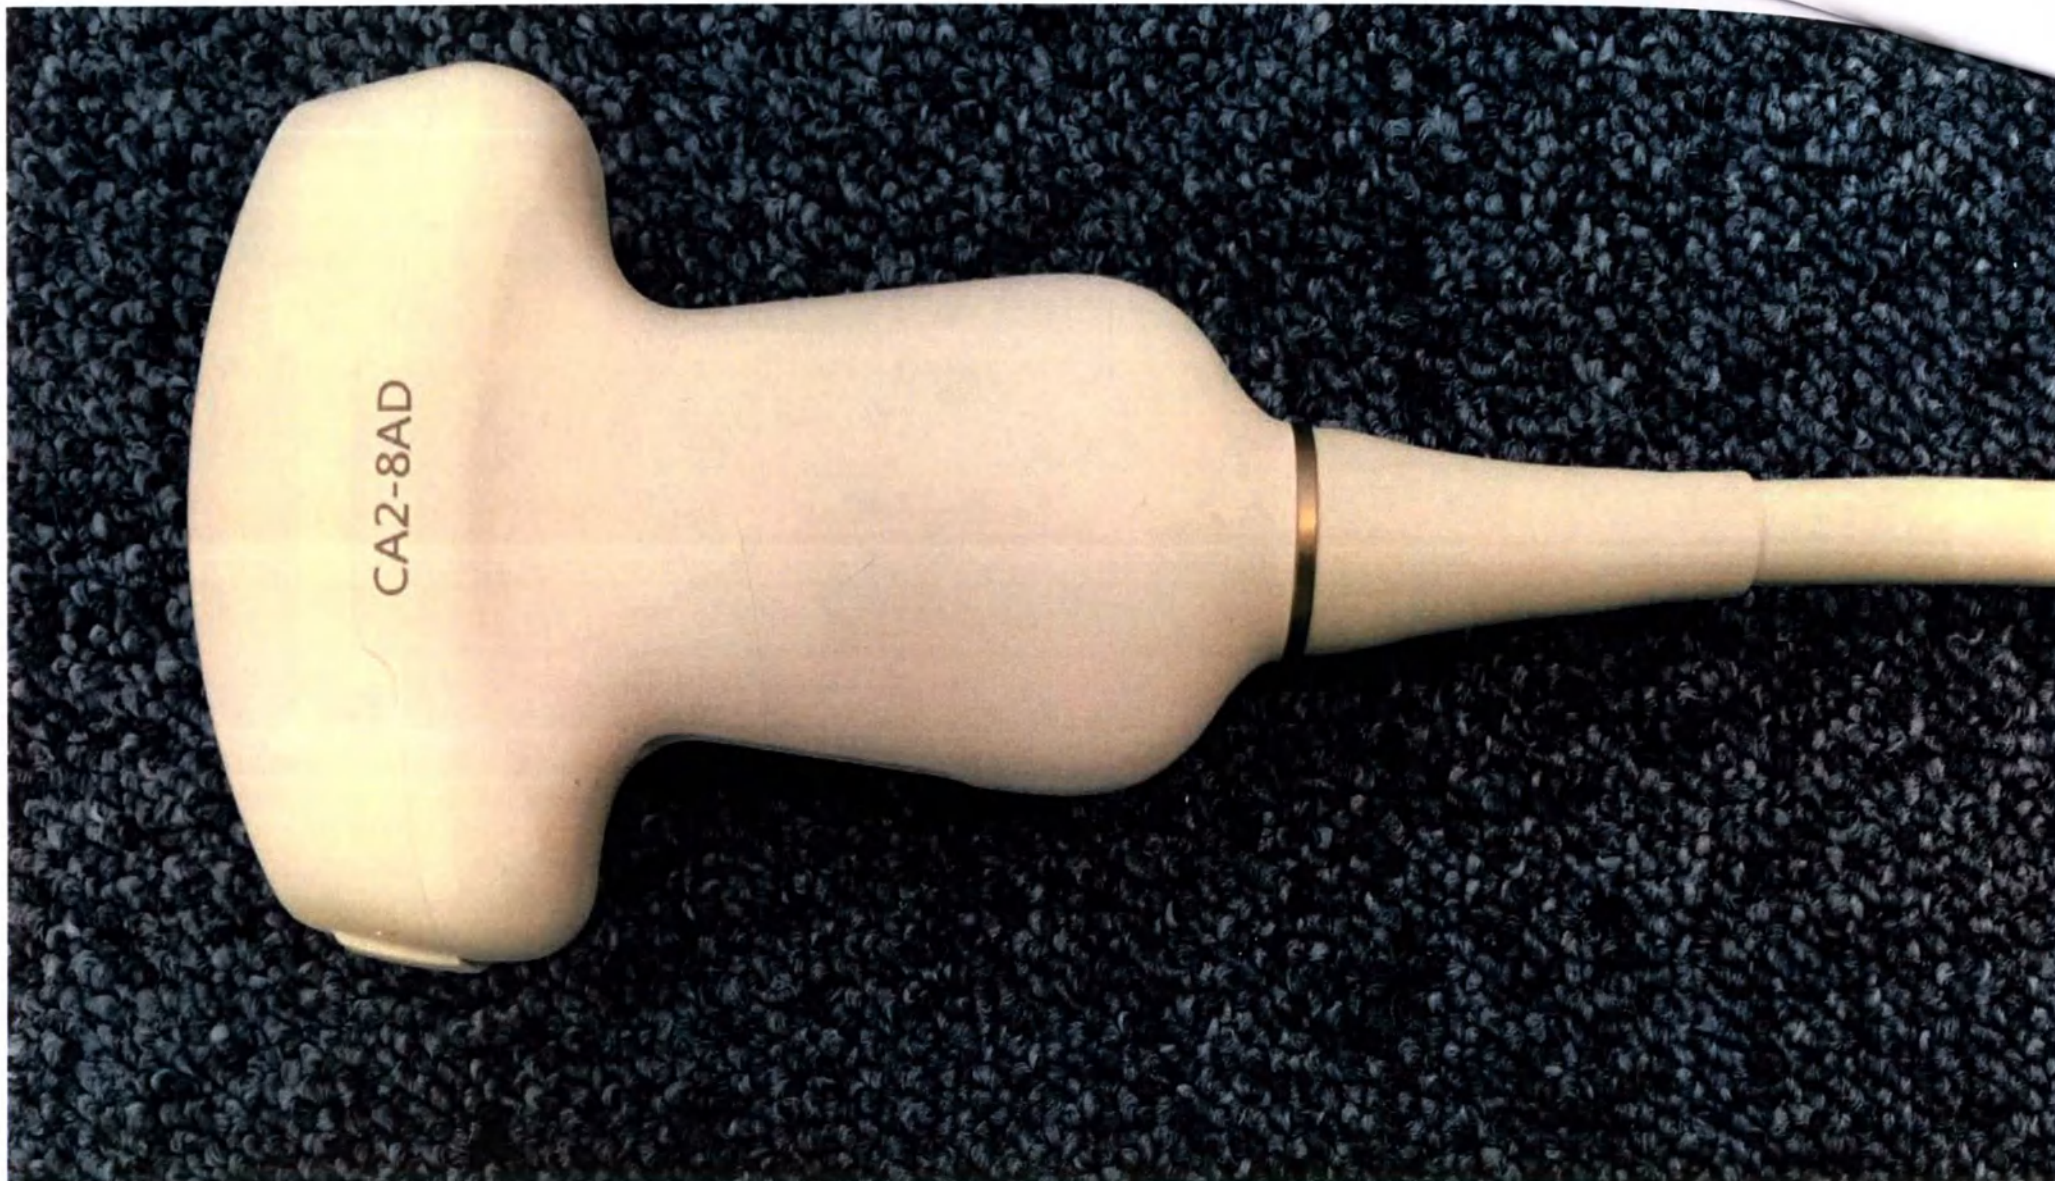

Датчик конвексный CA2-8AD




Датчик конвексный C2-8

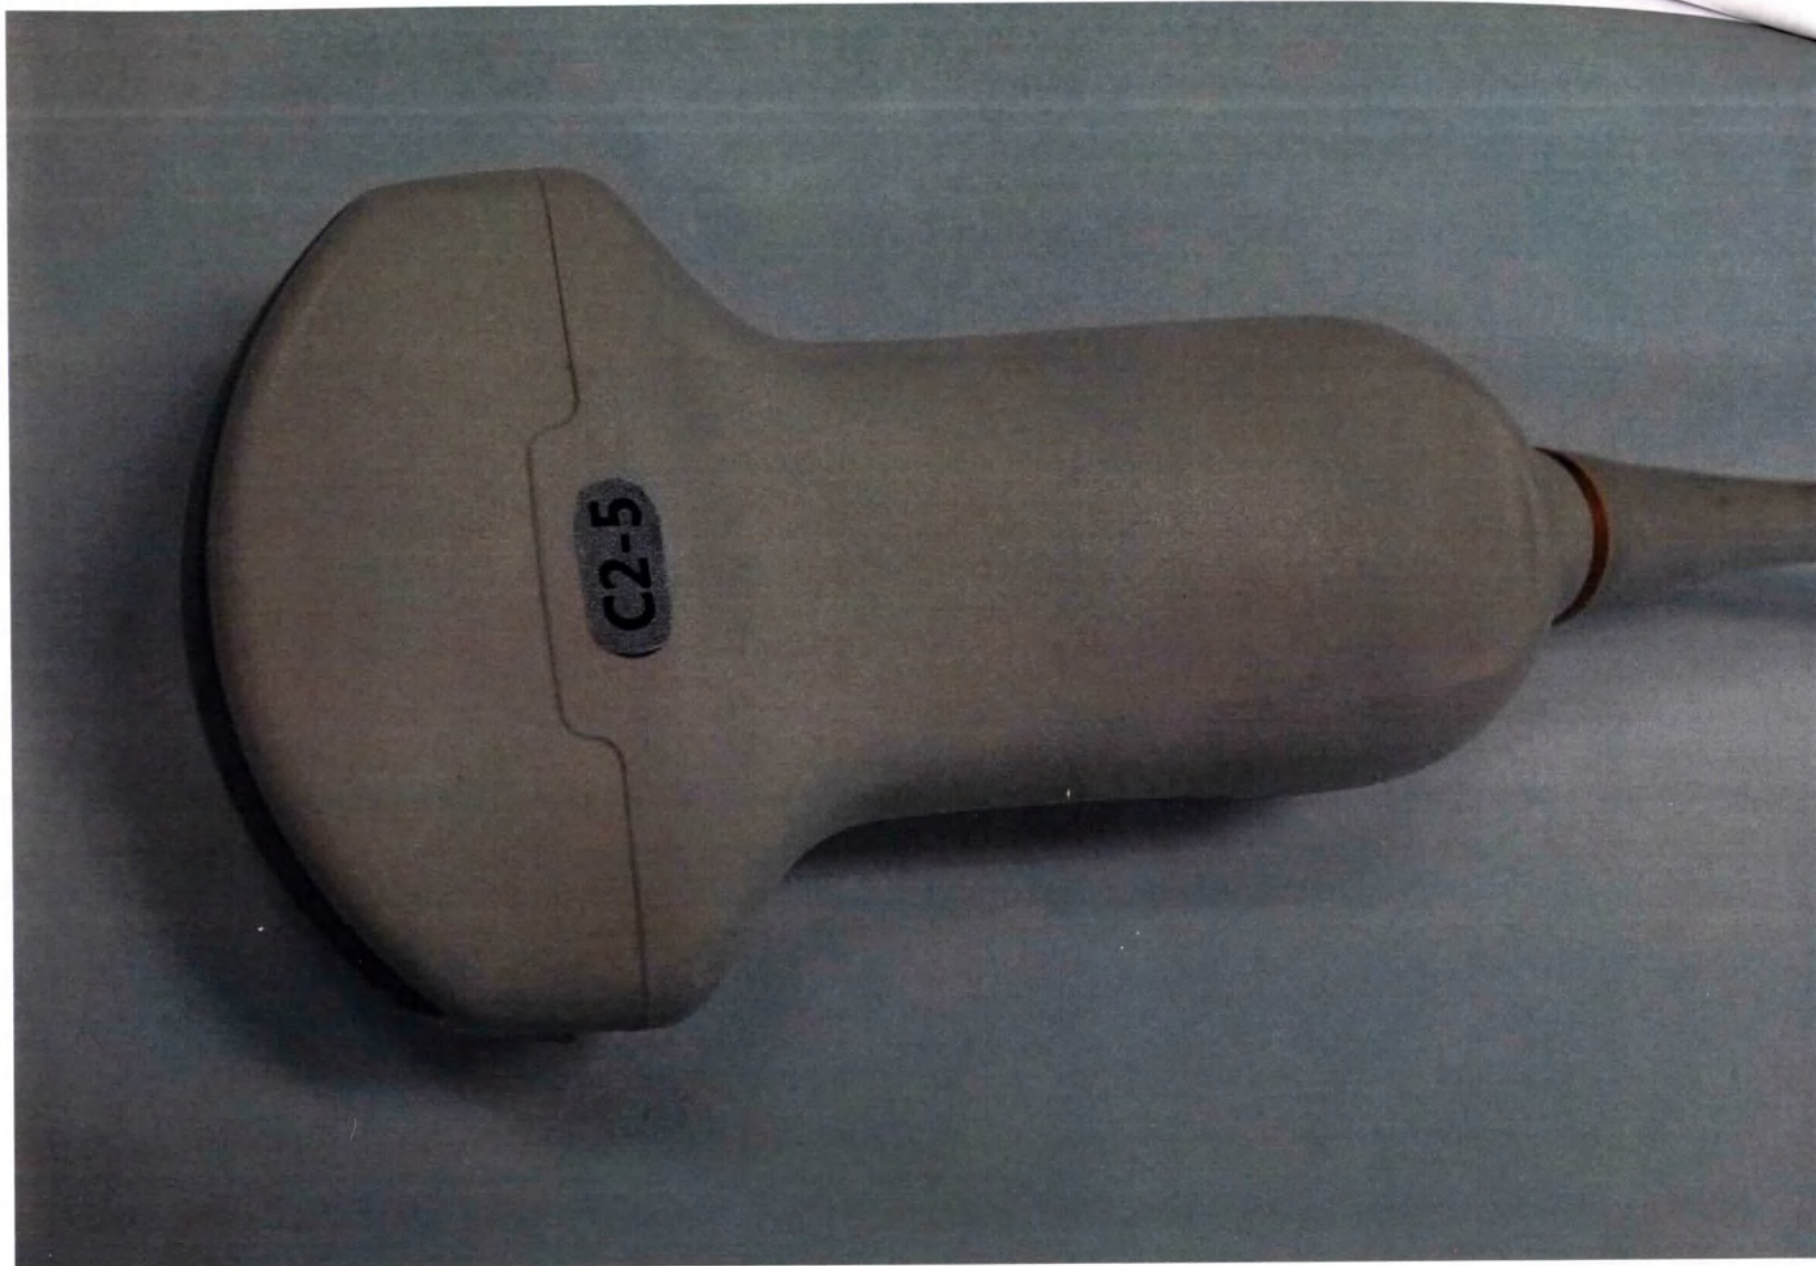


Датчик конвексный C2-5




Датчик конвексный CA1-7AD

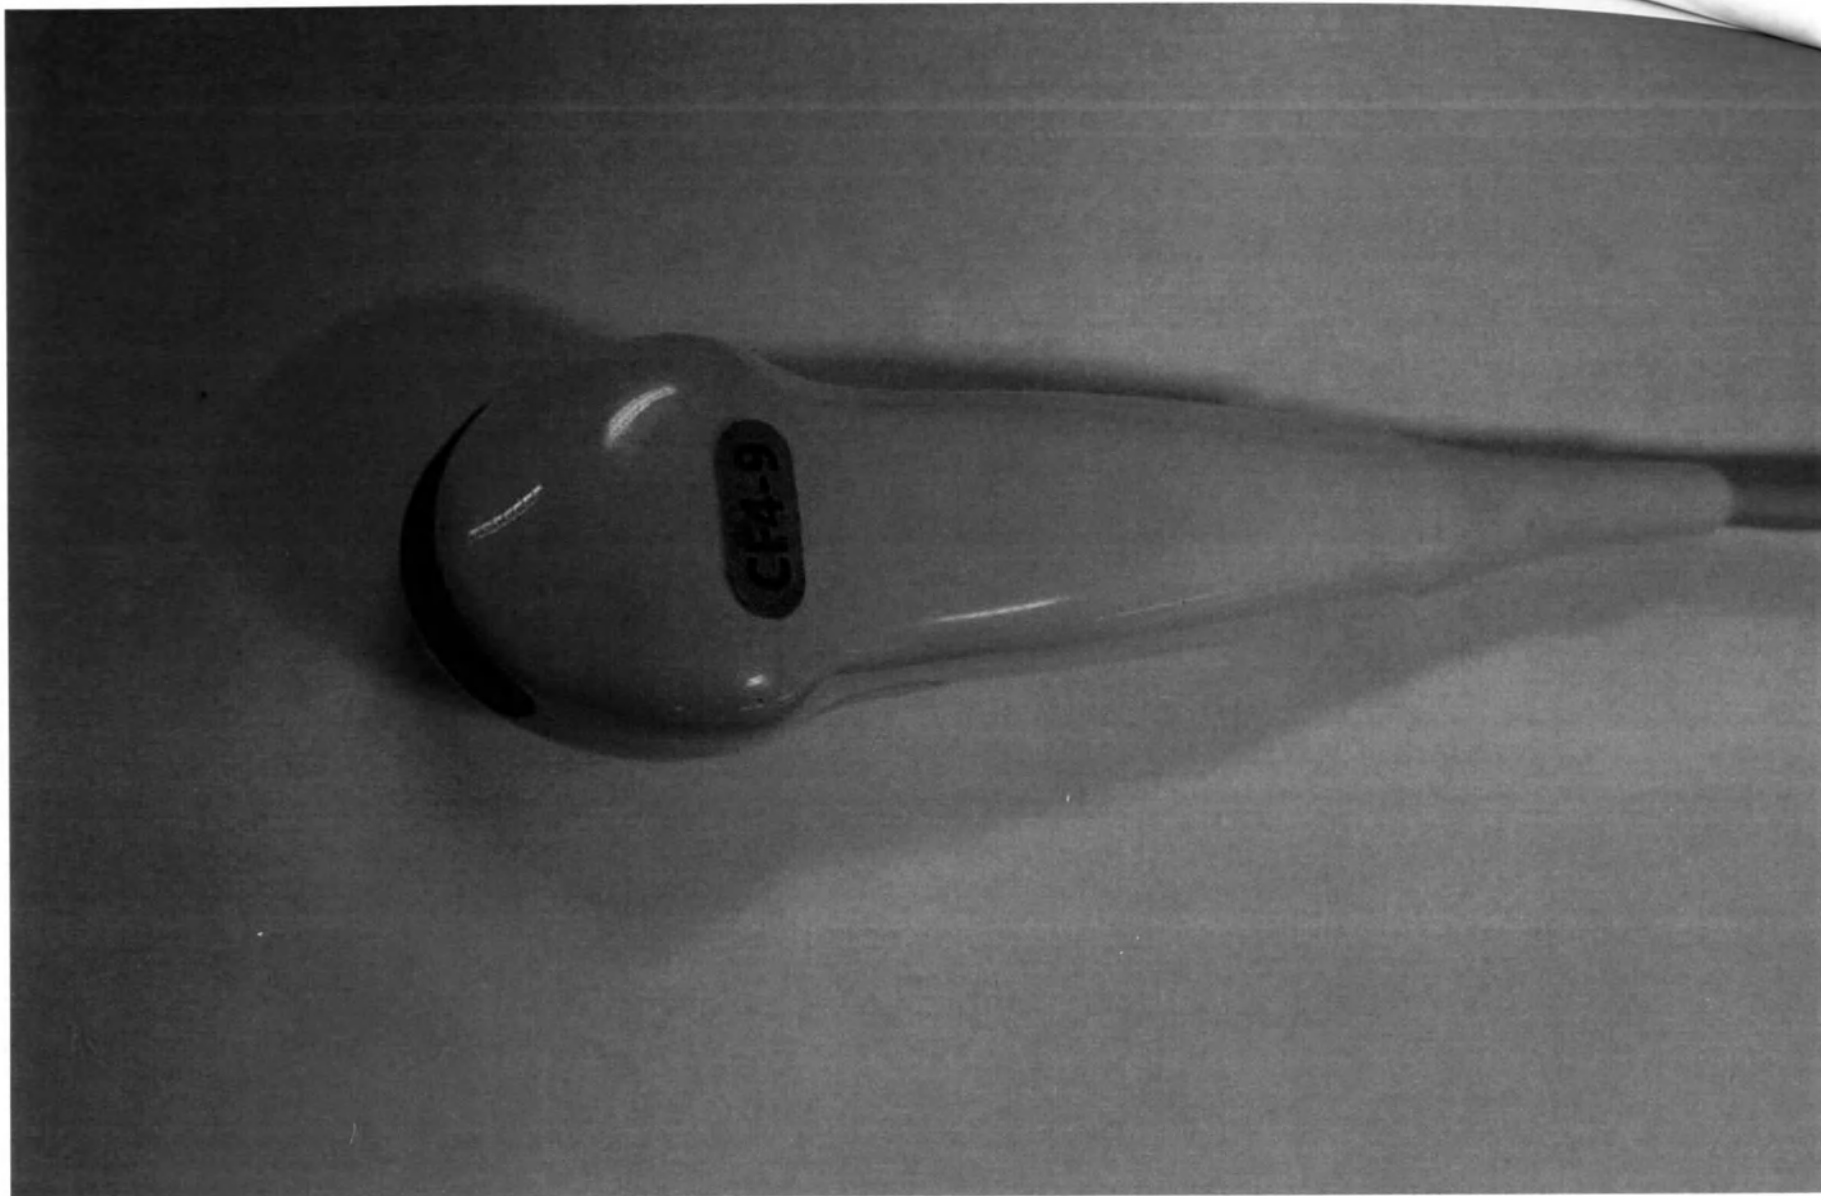

Датчик конвексный CF4-9

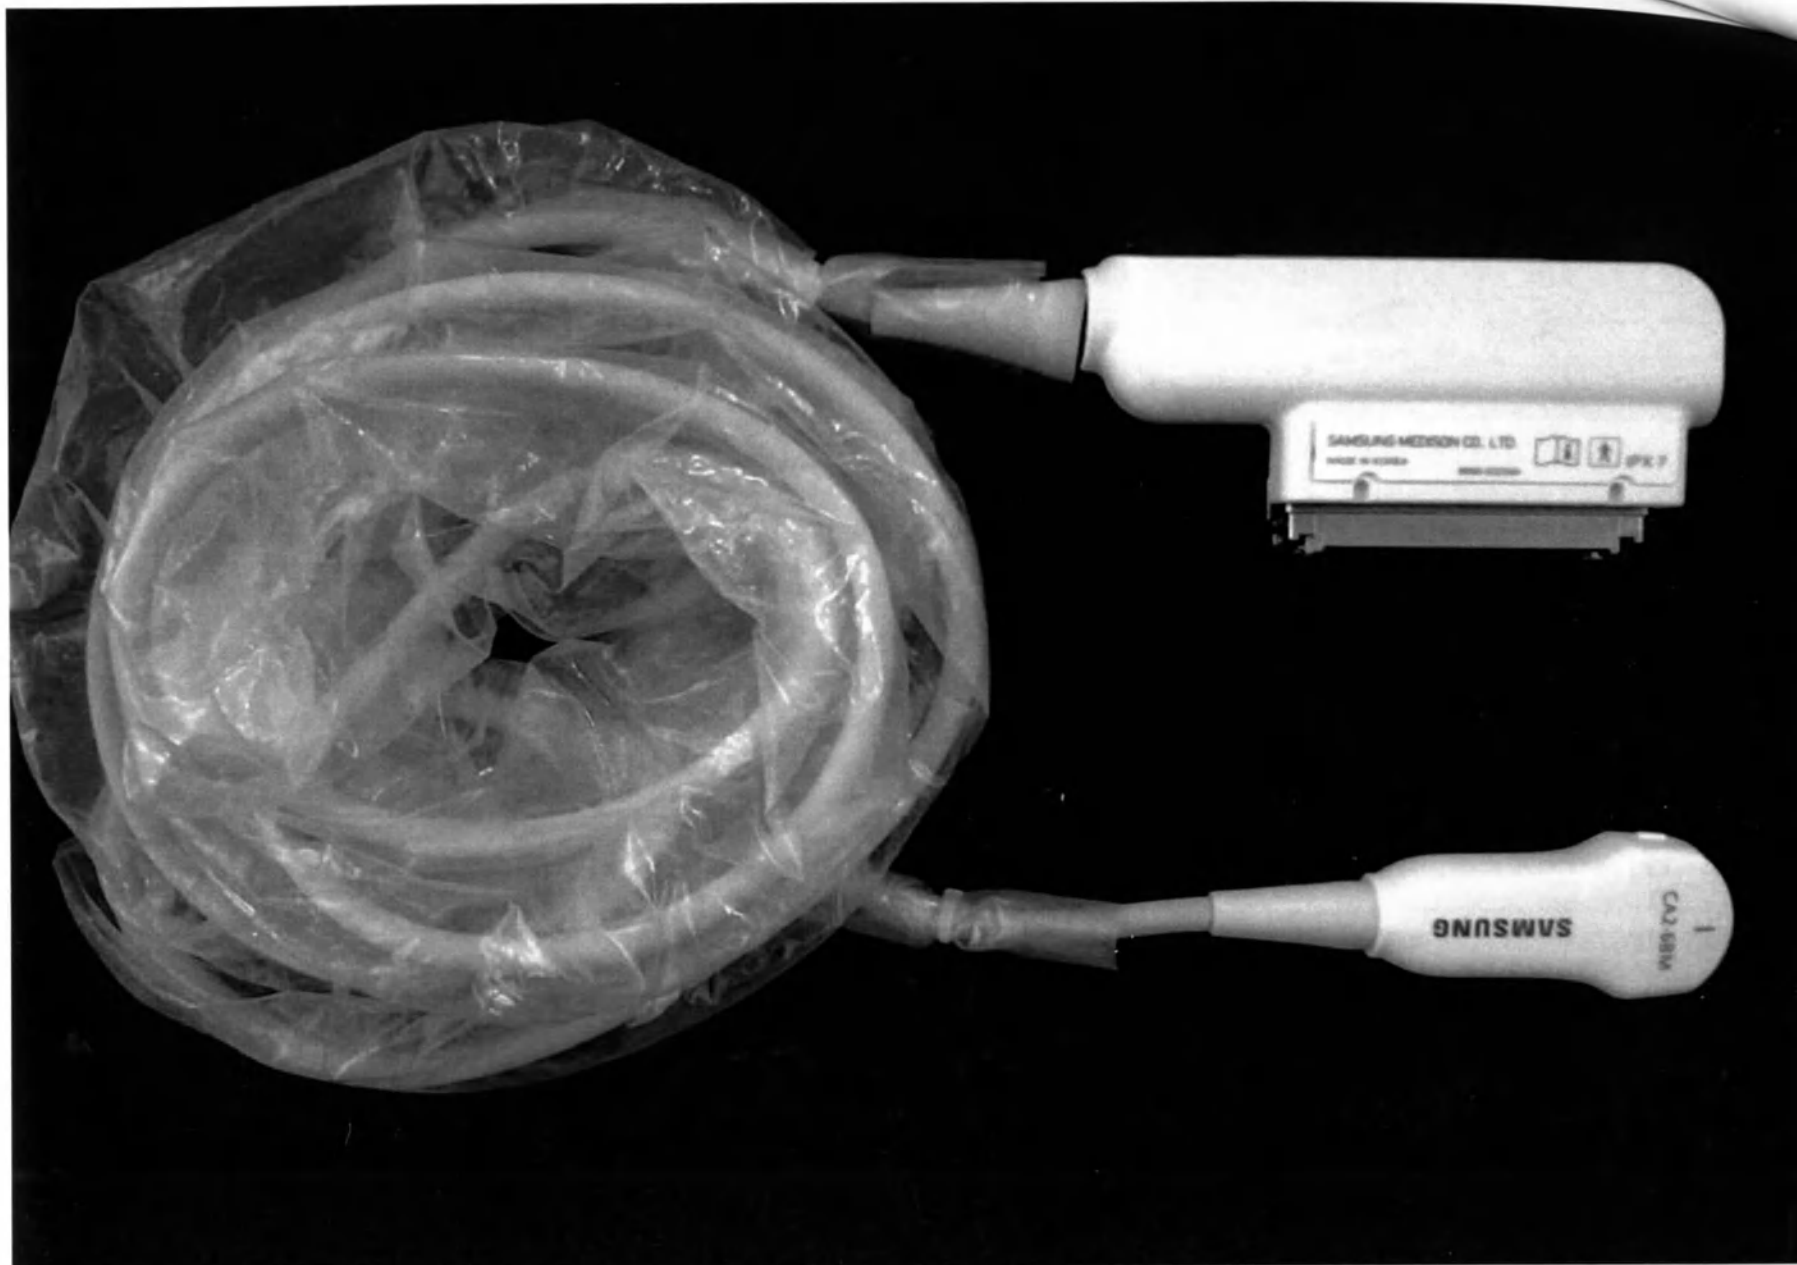

Датчик конвексный CA2-6BM

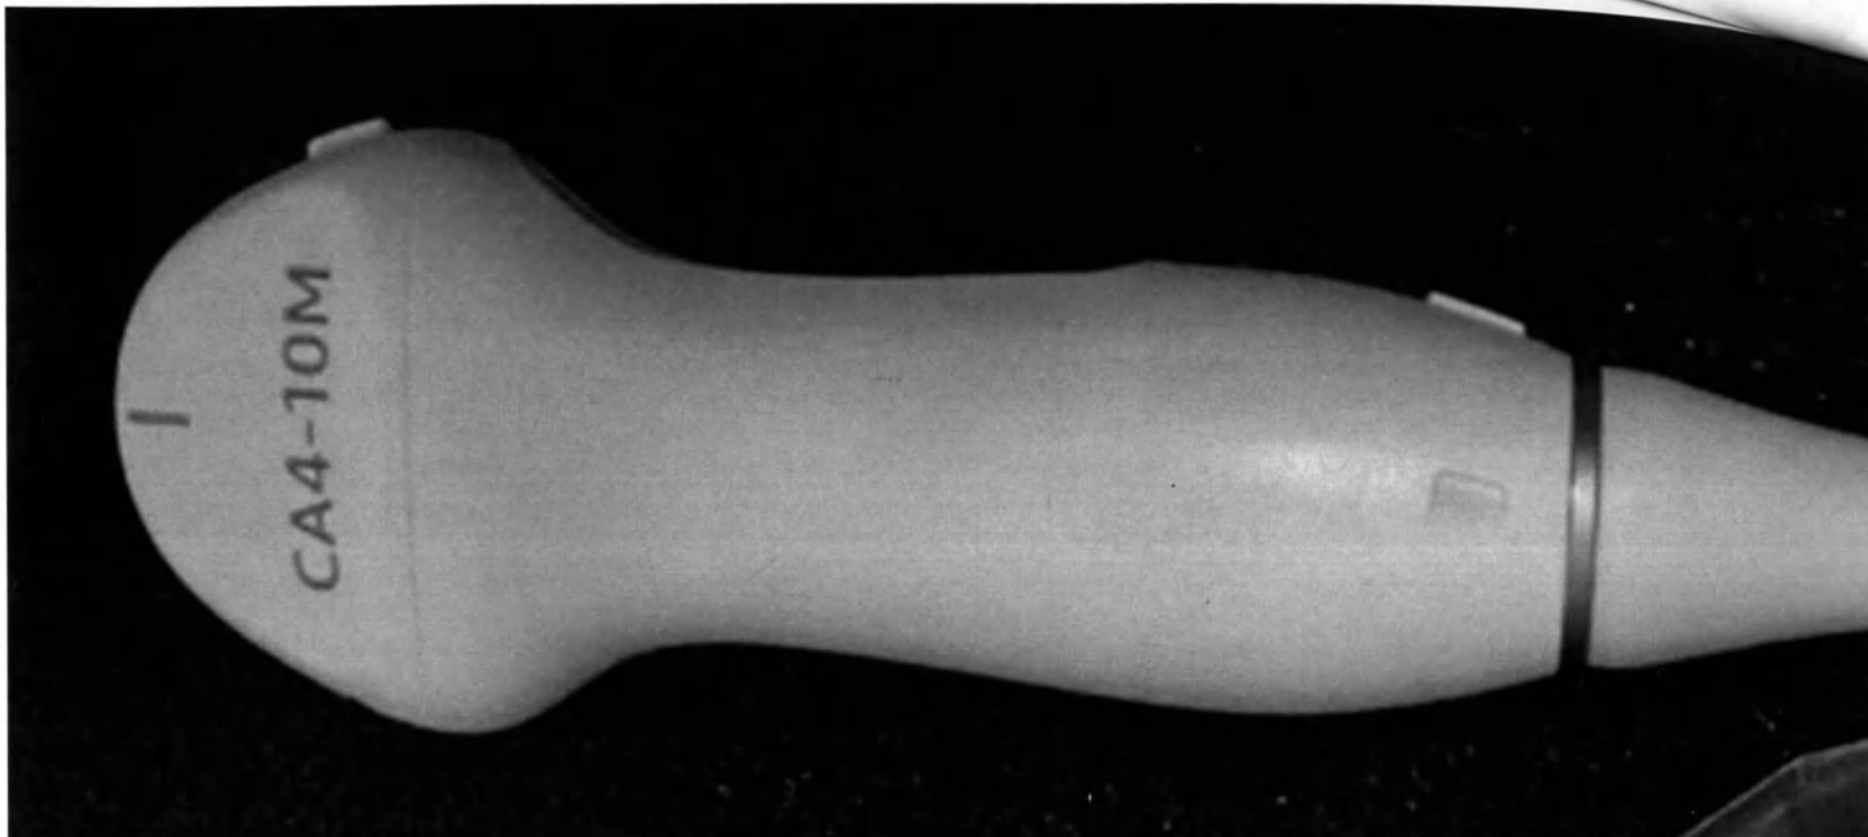


Датчик конвексный СА4-10М, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10698 от 22.08.2023 г.



Датчик эндовагитальный EVN4-9



Датчик эндокавитальный ER4-9

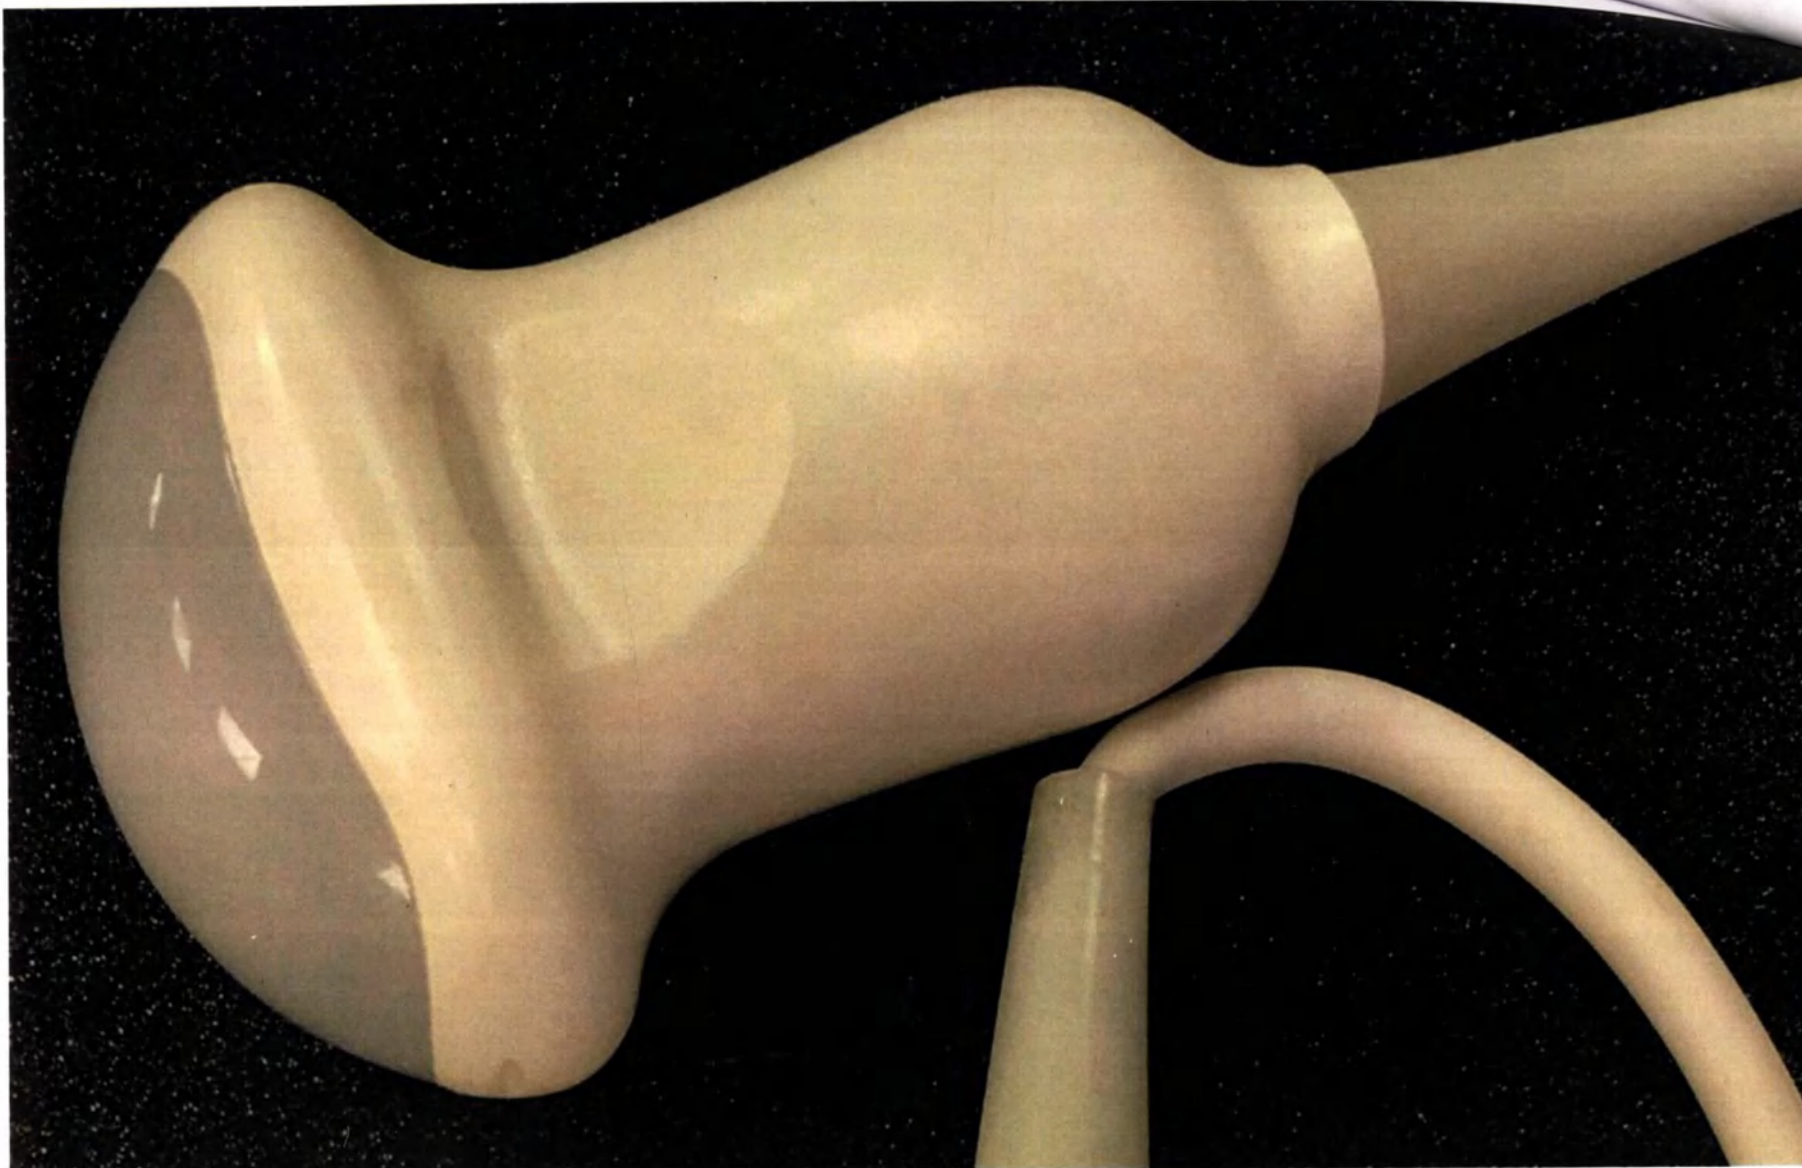


Датчик объемный VN4-8




Датчик объемный V5-9



Датчик объемный эндокавитальный EV2-10A

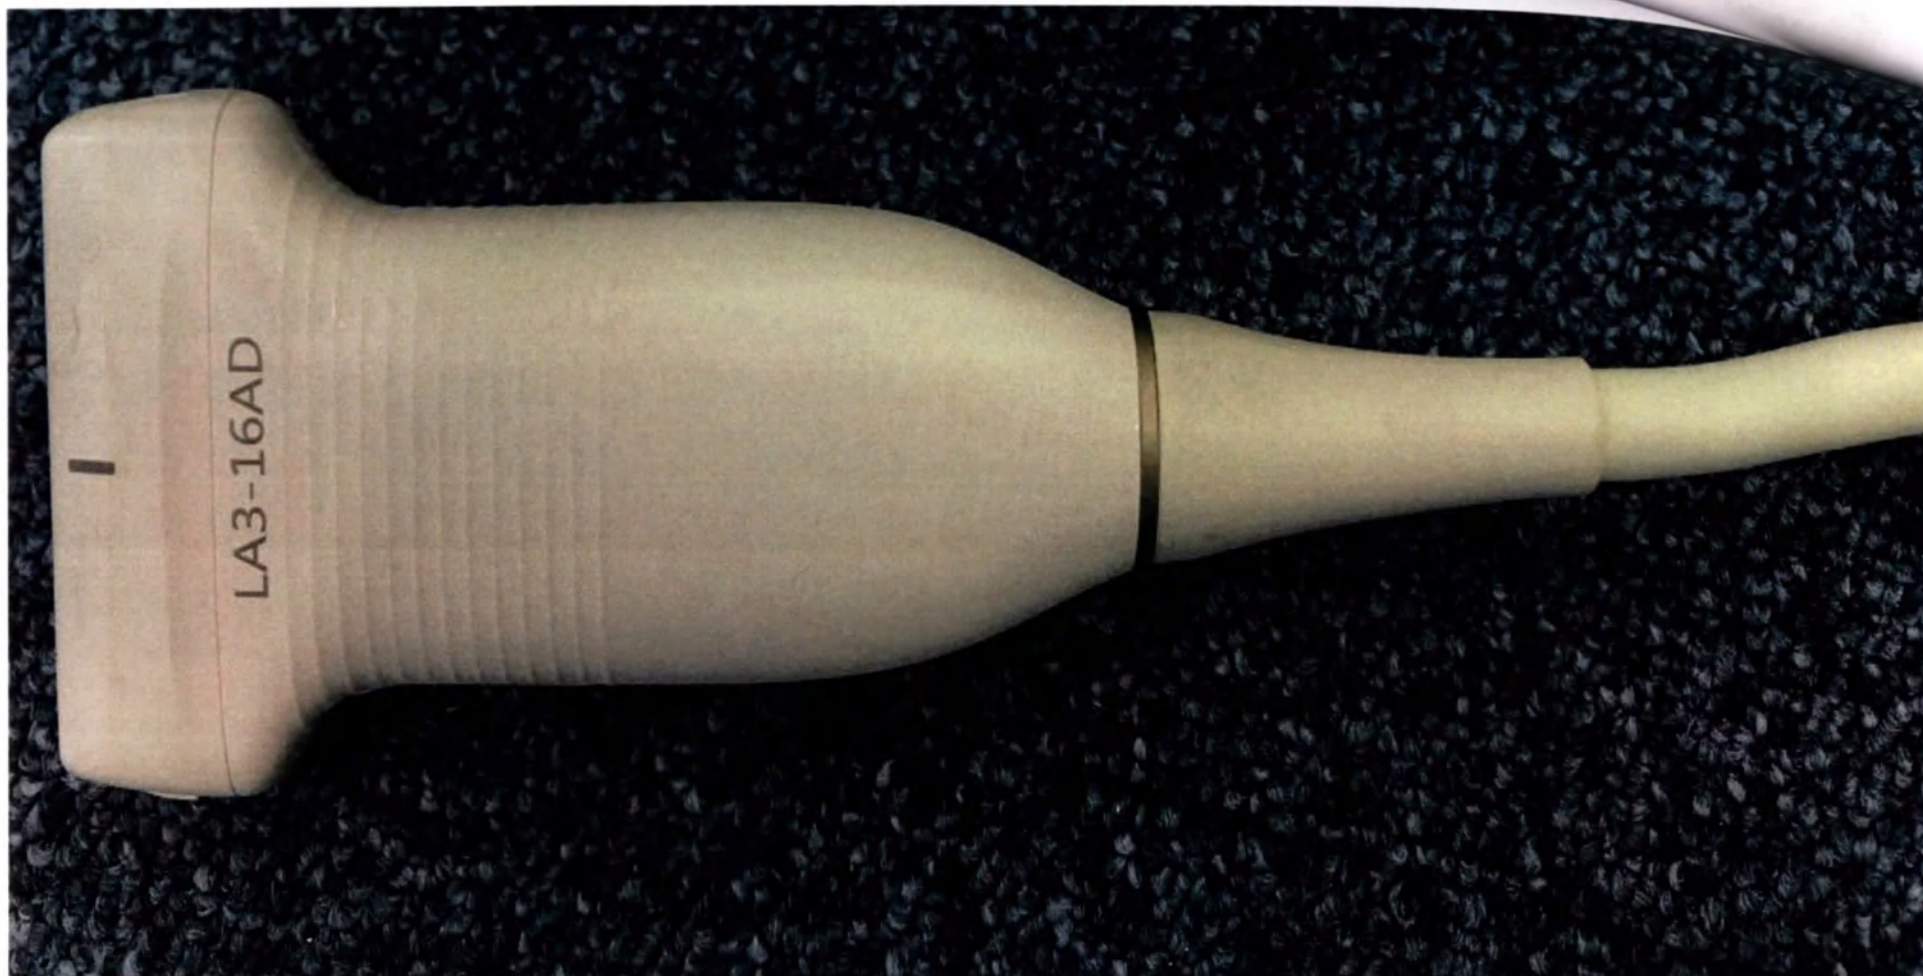

Датчик линейный LA3-16AD

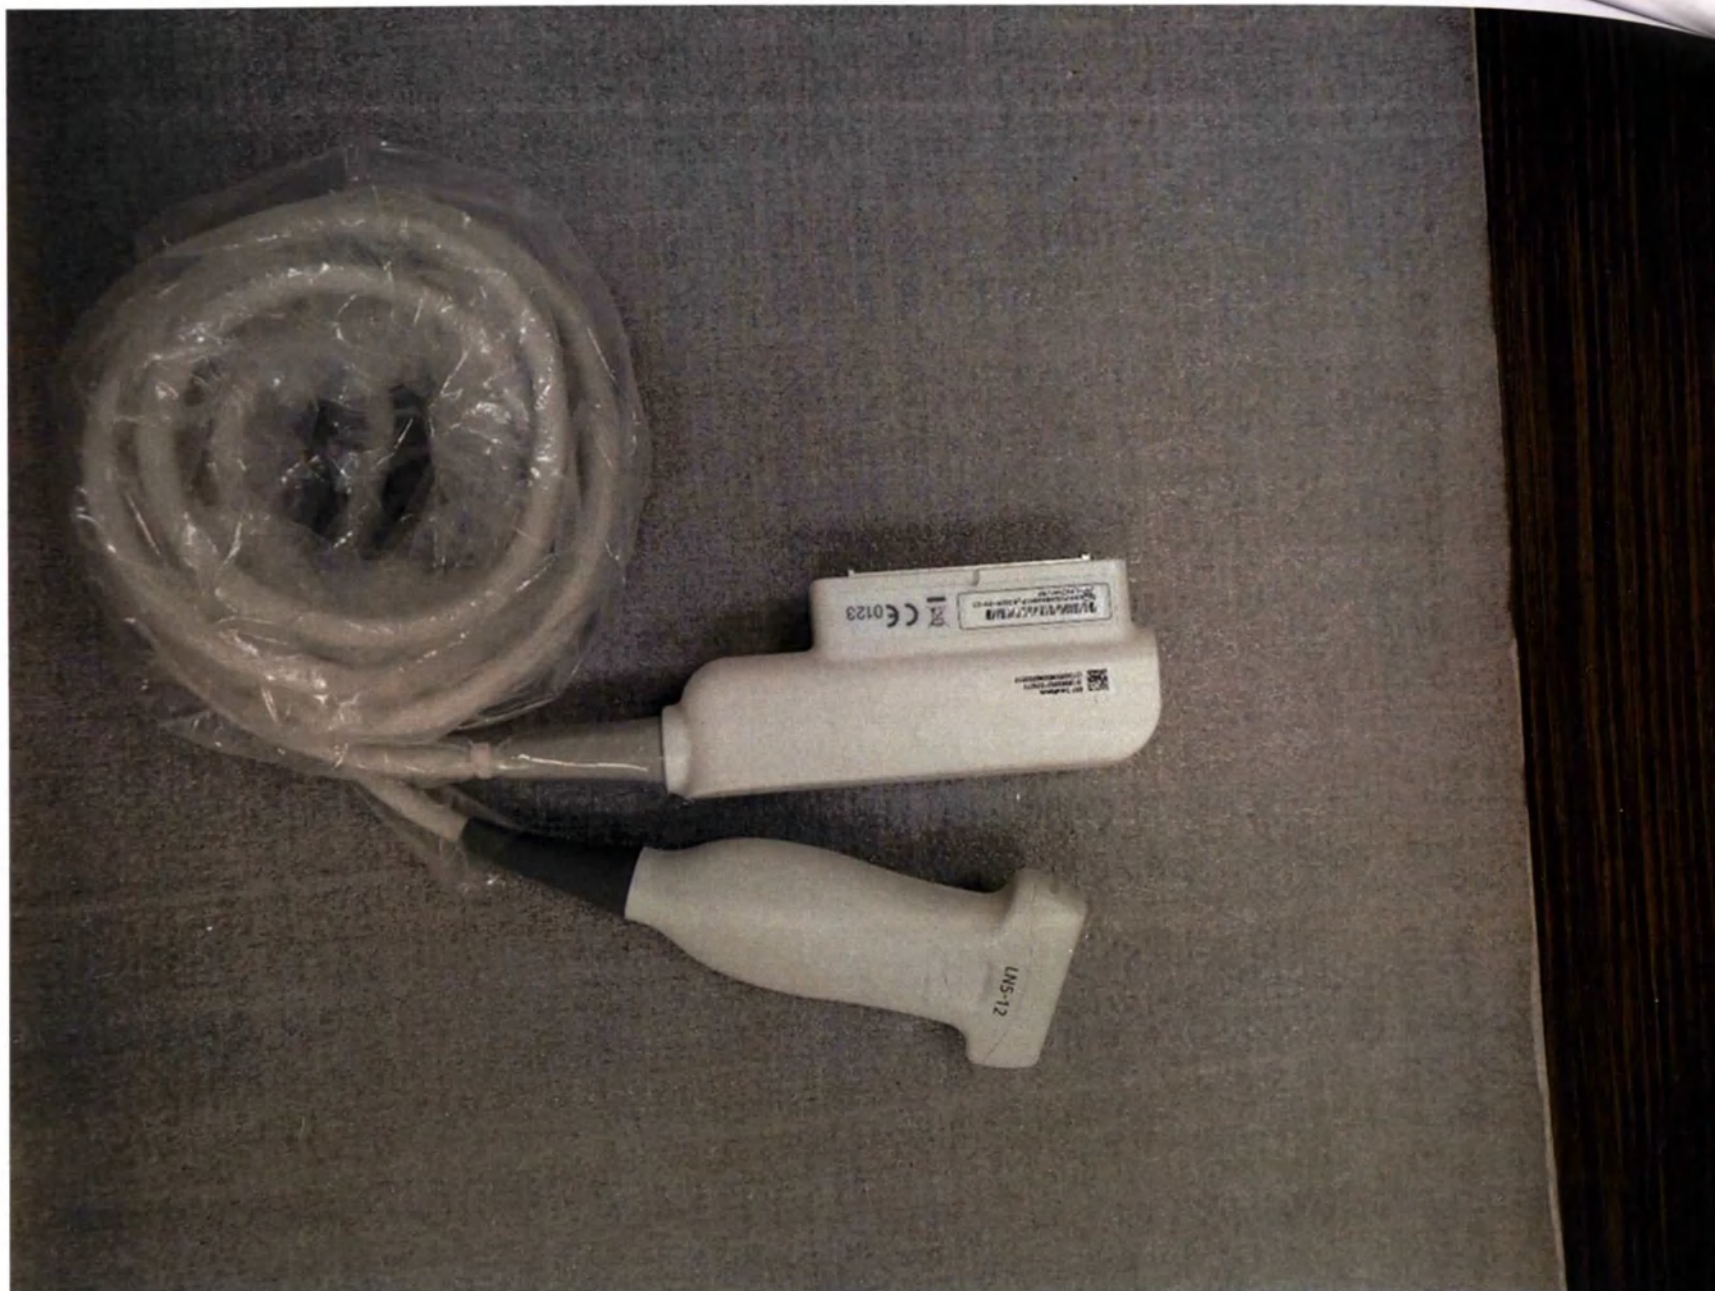


Датчик линейный LN5-12



Датчик линейный L5-12/50



Датчик линейный LA2-9A

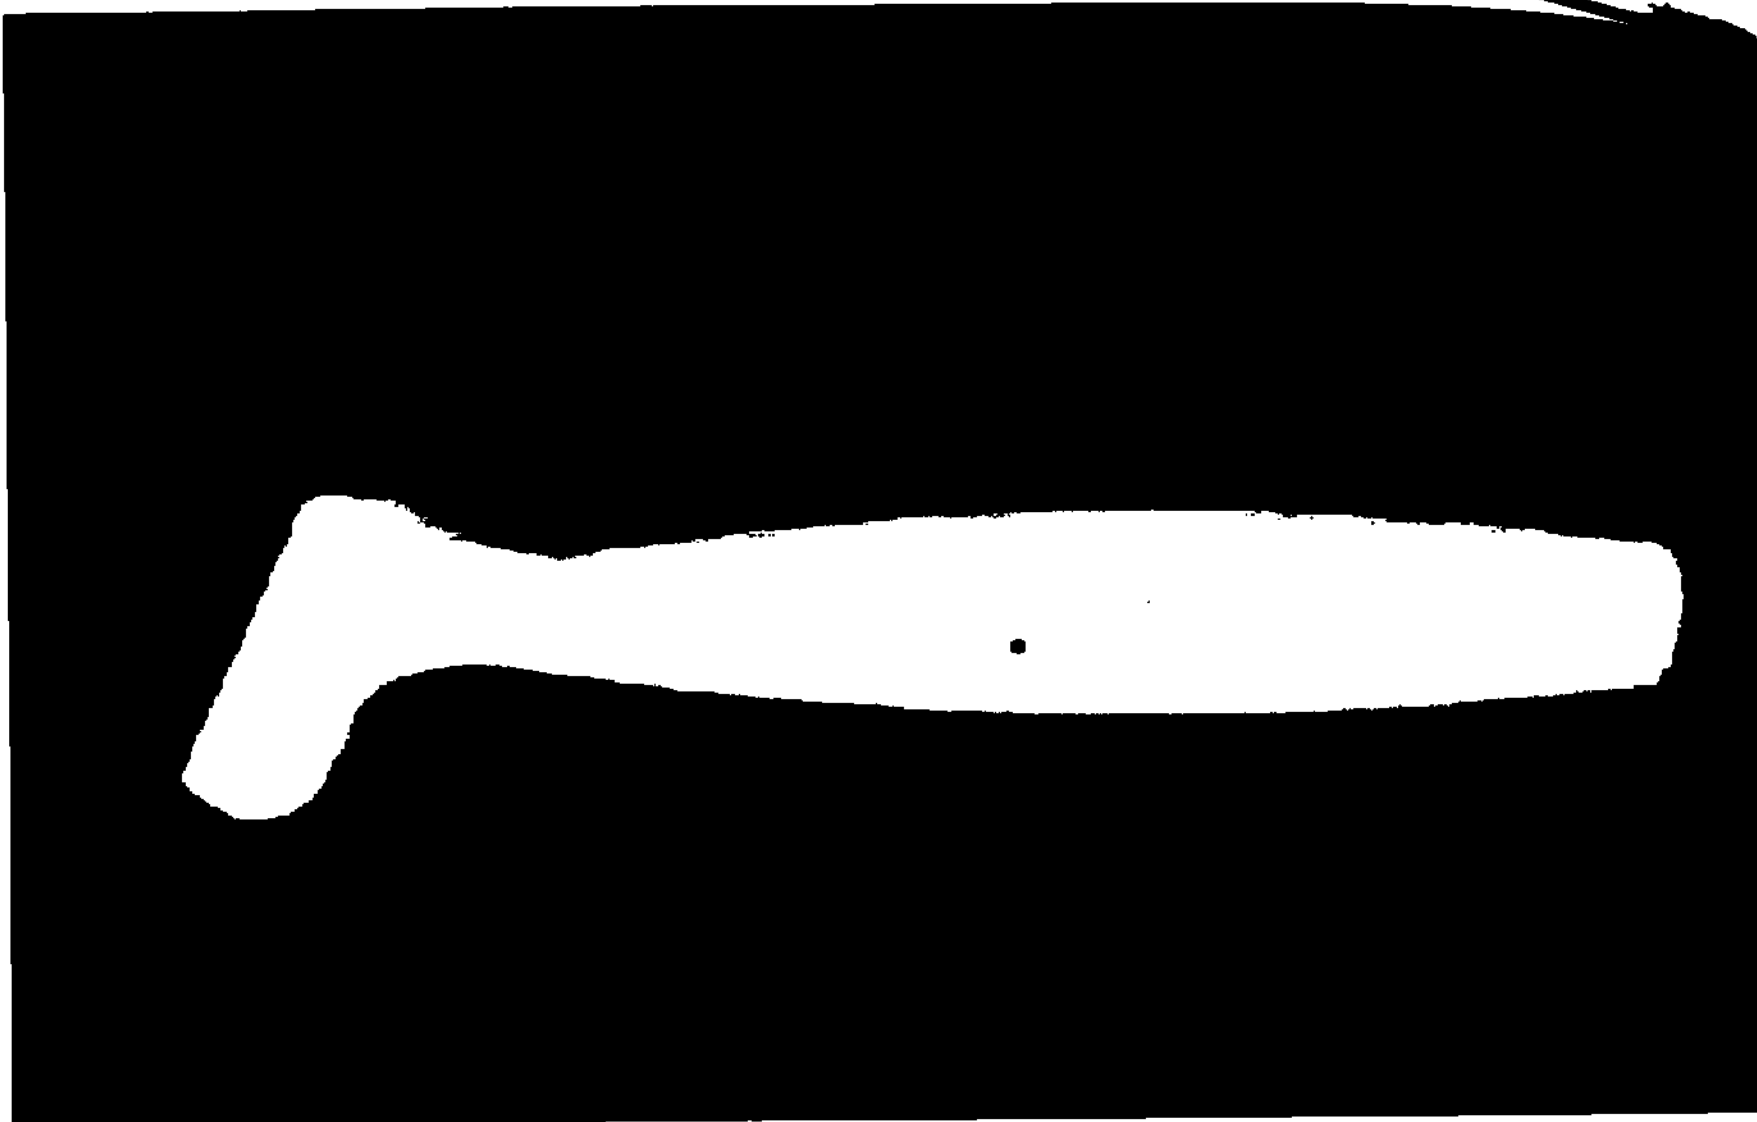

Датчик линейный LA3-16AI




Датчик линейный LS3-14B



Датчик линейный L4-7



Датчик линейный LS6-15

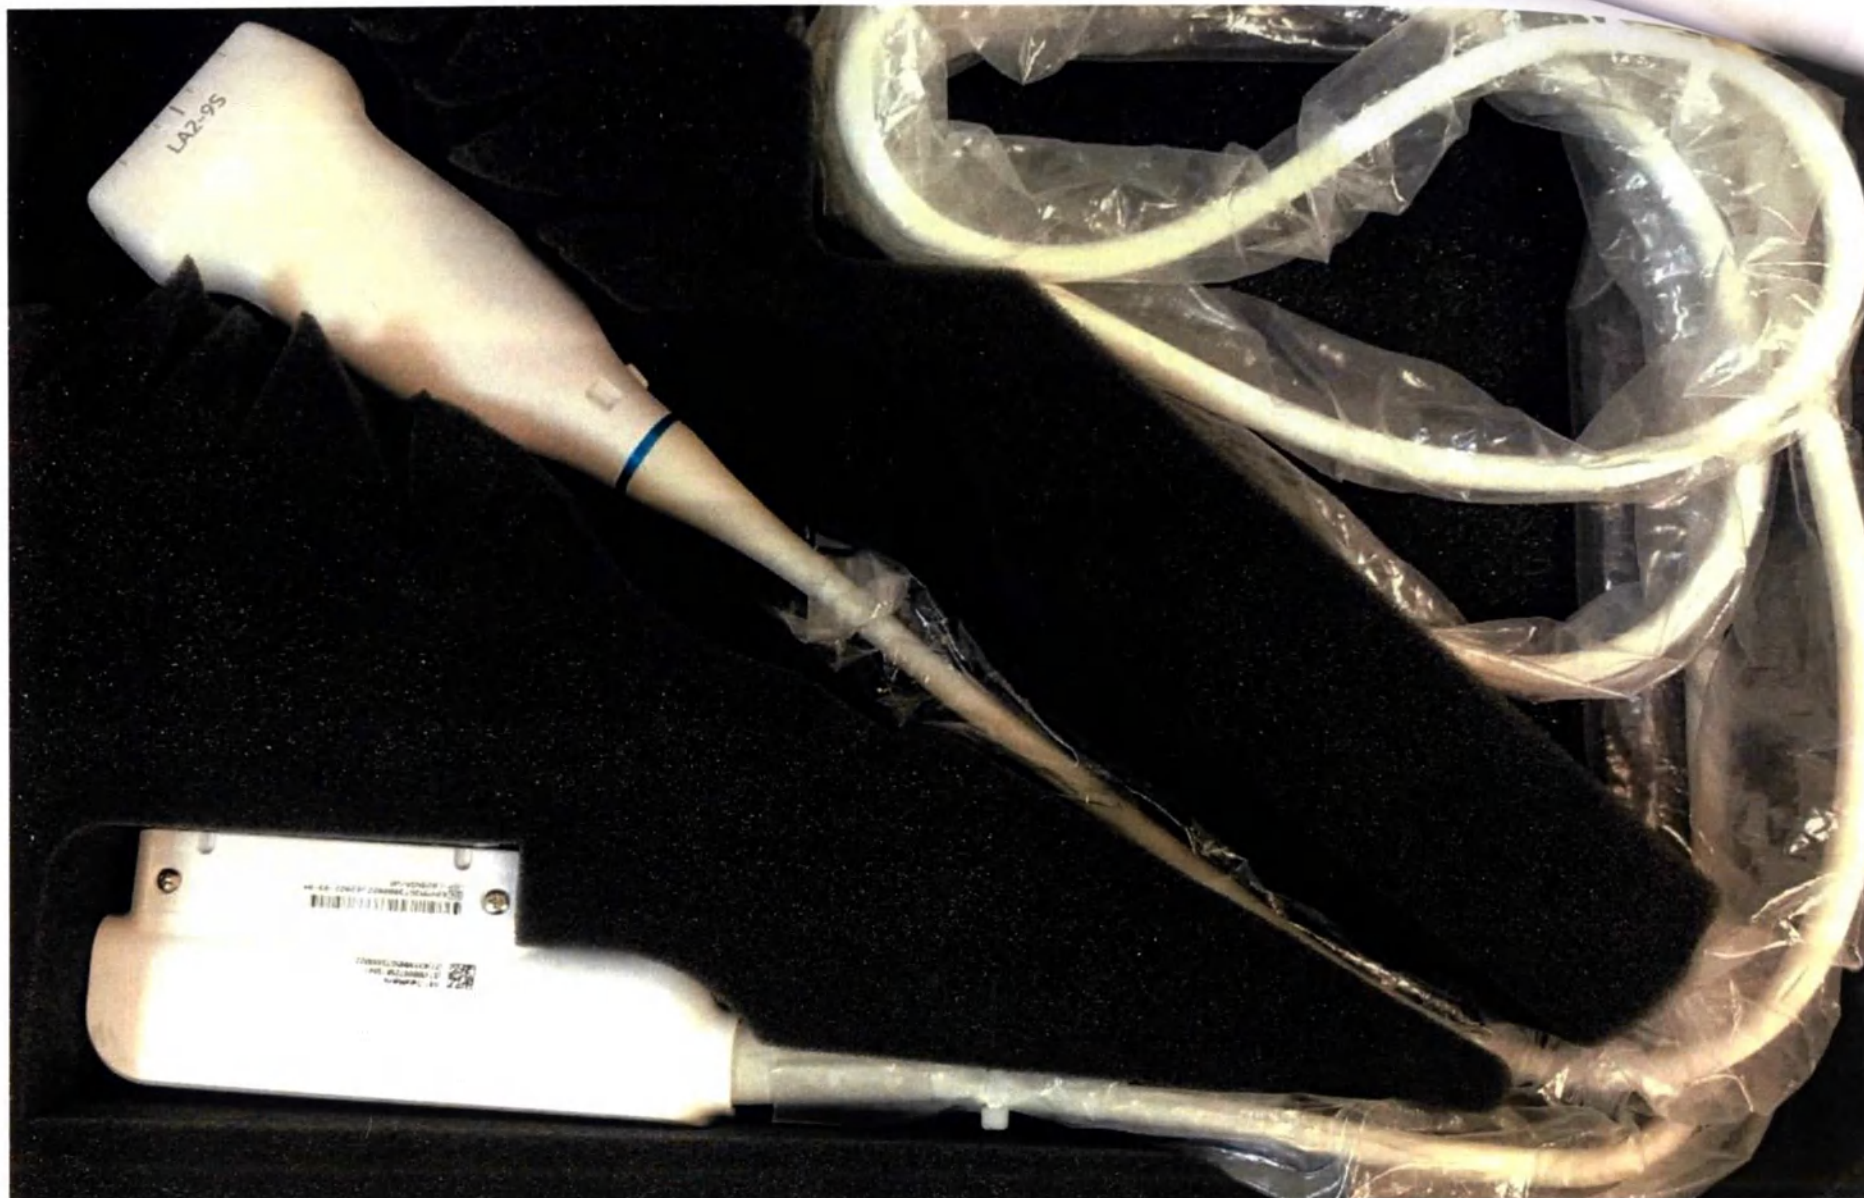


Датчик линейный LA2-9S, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10698 от 22.08.2023 г.

Датчик линейный L3-22





Датчик линейный LA3-22AI, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10698 от 22.08.2023 г.

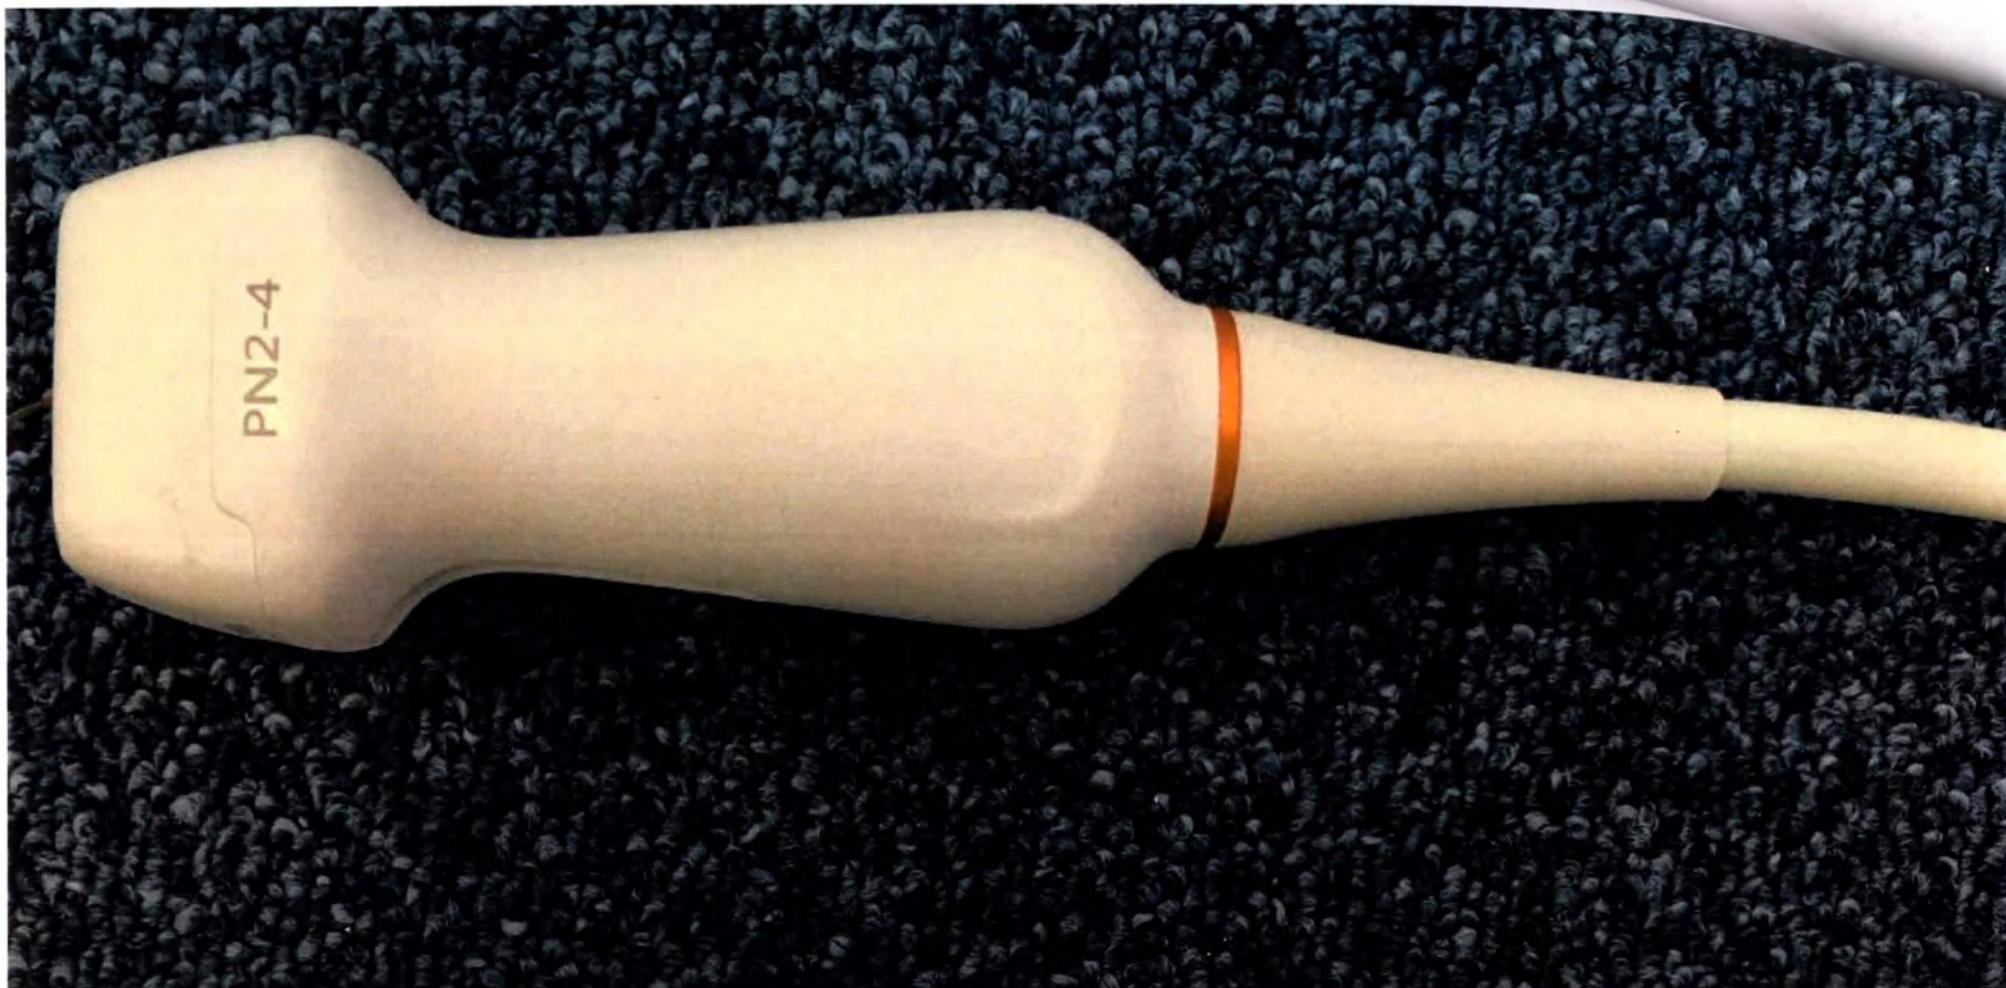


Датчик фазированный PN2-4



Датчик фазированный PA1-5AD

Датчик фазированный SP3-8

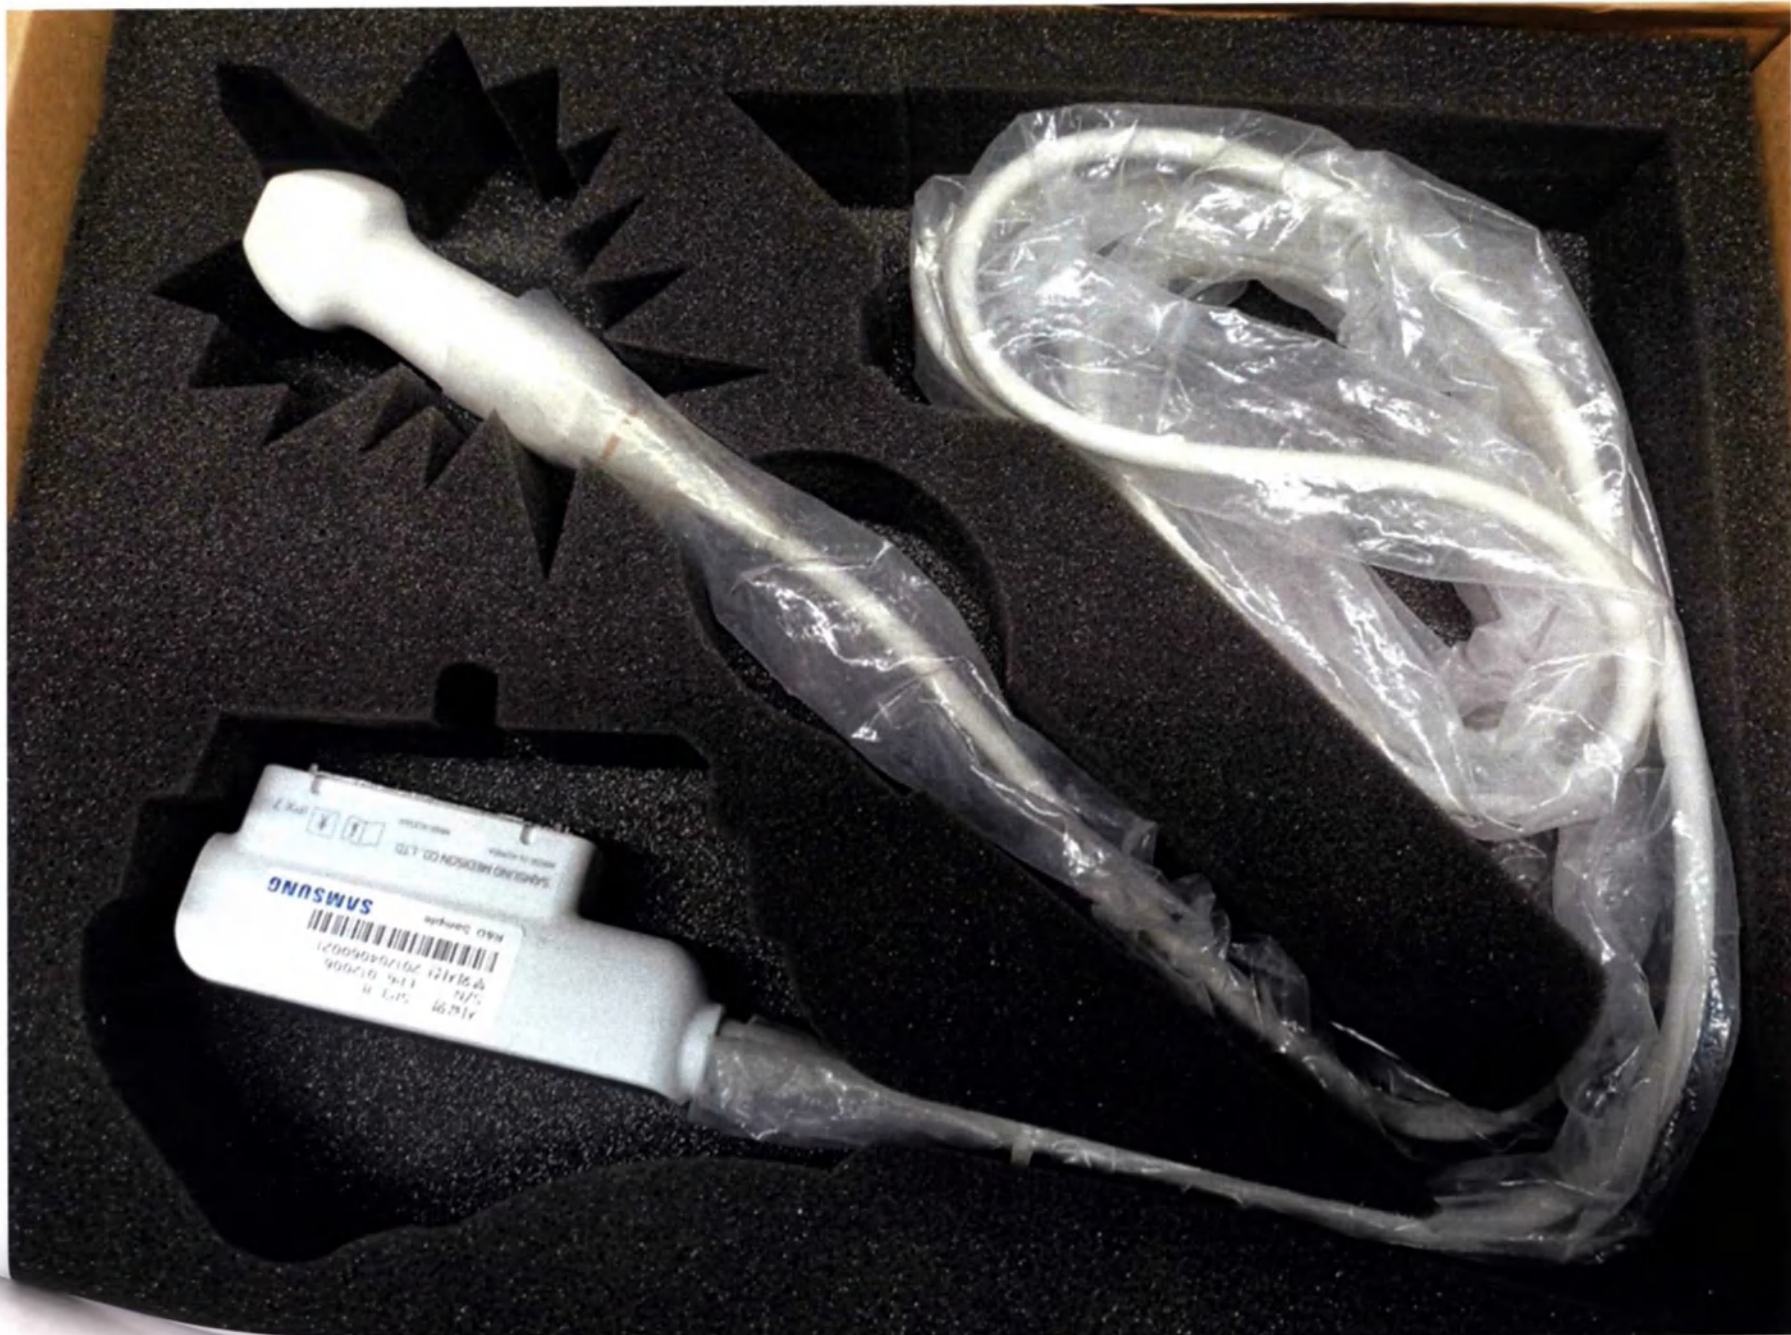



Датчик фазированный PA1-5A, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10698 от 22.08.2023 г.



Датчик фазированный PA3-9B, производства фирмы SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Республика Корея, регистрационное удостоверение № P3H 2020/10698 от 22.08.2023 г.




Датчик фазированный чреспищеводный ММРТЗ-7



Датчик постоянно-волновой DP2B



Датчик постоянно-волновой DP8B

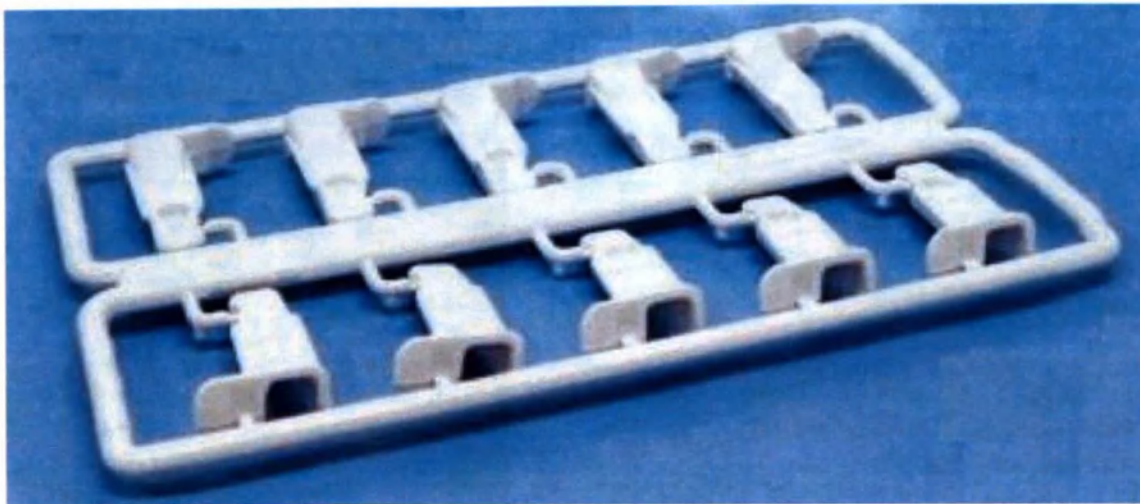

Крепления иглопроводника



Иглопроводник



Насадка для биопсии

Набор для биопсии



Трехпортовый коннектор (с разъемом для постоянно-волнового датчика)



Флэш-накопитель данных



Модуль ЭКГ




Четырехпортовый (с разъемом для постоянно-волнового датчика)



Четырехпортовый коннектор



- Трехпортовый коннектор

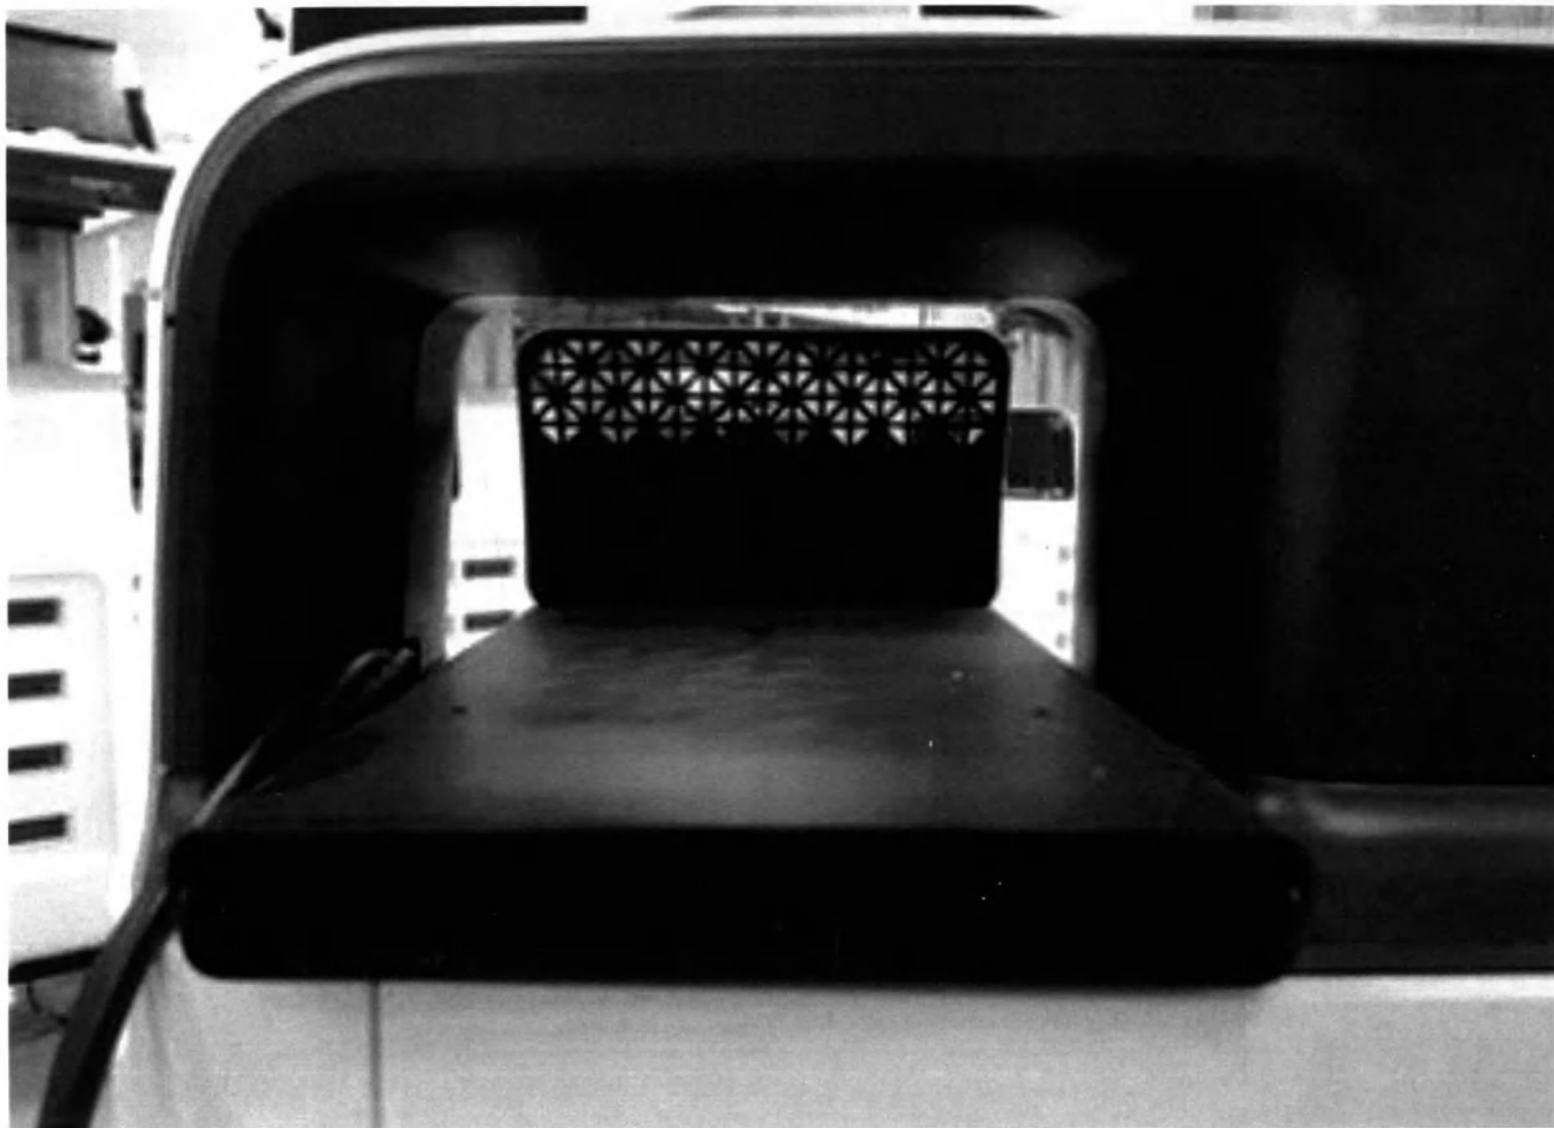

Лоток принтера



Подогреватель геля



Переключатель ножной



Дополнительная батарея



Встраивается внутрь системы

Устройство для расширения емкости хранения данных (1 ТБ)

Лицензионные ключи представляют собой буквенно-цифровые коды. Таким образом, предоставление фотографических изображений не представляется возможным.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 43 листа

Генеральный директор
ВАО «Медийс»

Н.В. Викторс