


Фотографические изображения
Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active)

Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 10 шт.



4x44x80 Var. I

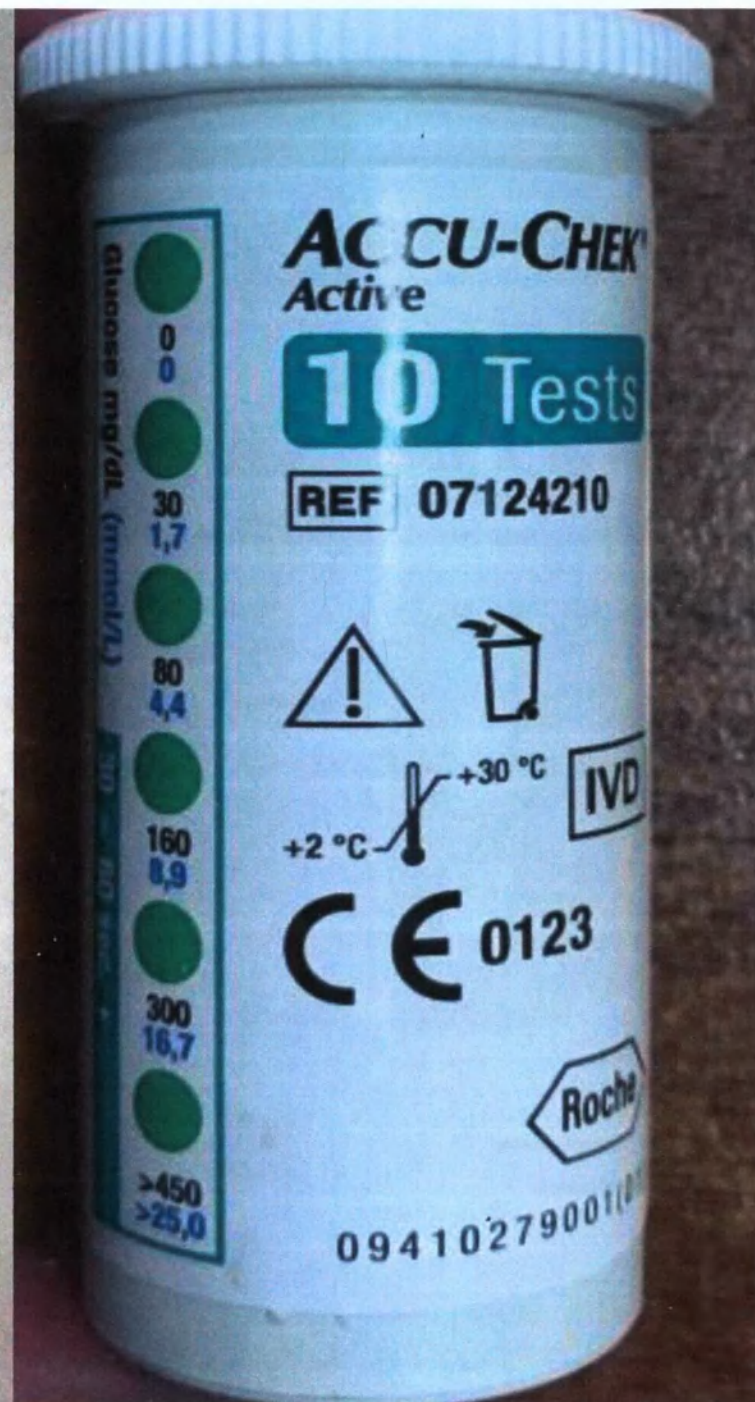

1. Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 10 шт – макет маркировки на русском языке

Тест-полоски "Акку-Чек Актив"

(Accu-Chek Active), 10 шт.

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2008/01205 от _____

Производитель, изготовитель:

"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Сандхофер

Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия

Сделано в Германии

Импортер, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,


107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: 8-800-200-88-99

Е-mail: info@accu-chek.ru

Кат.номер: 07124210190 RU_097_XX_V2

2. Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 50 шт.

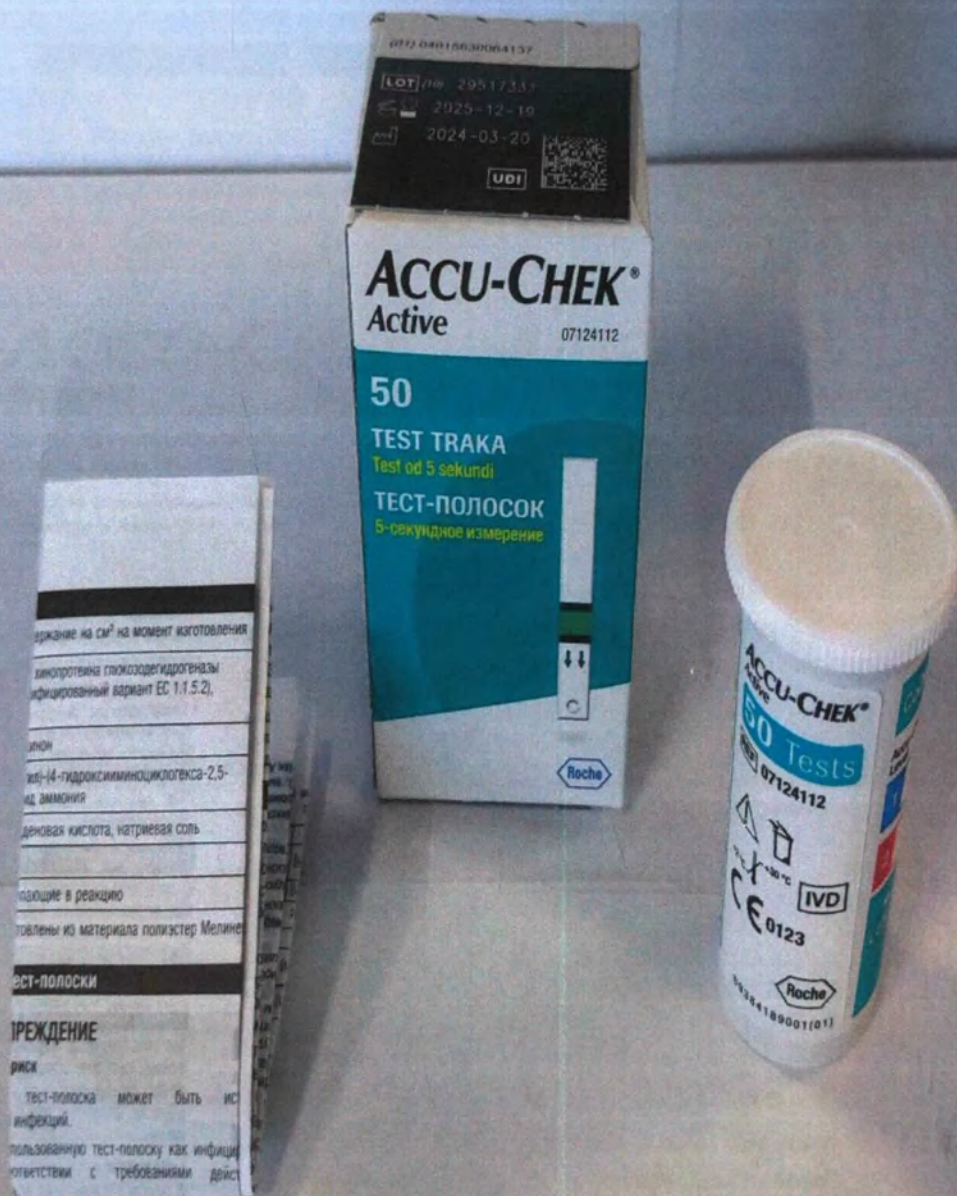

Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 50 шт. – макет маркировки
4x44x80 Var. I



3. Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 100 шт.



Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 100 шт. – макет маркировки

80x44x80 Var. H

DLF

АККУ-ЧЕК®
АКТИВ

07124287

2 x 50

ТЕСТ-ПОЛОСОК
5-секундное измерение

ТЕСТ-СМУЖОК
5-секундні визначення



DLF

10

Плотно закройте тубус
крышкой сразу после того,
как Вы достали из него
тест-полоску.


Щільно закривайте кришкою
контейнер відразу після
витягування тест-смужок.

(EN) For the determination of blood glucose
Only for Accu-Chek® Active

(PTB) Autoteste para monitoramento de
glicemia do sangue, sem fins diagnósticos
Só para Accu-Chek® Active
Uso em diagnóstico in vitro
Leia cuidadosamente as instruções de
uso antes de realizar o teste

(RU) Для определения глюкозы крови
Только для Акку-Чек® Актив

(UK) Для визначення рівня глюкози у крові
Тільки для Акку-Чек® Актив



CE 0123 +2 °C +30 °C

ACCUCHEK and AKKUCHEK are trademarks of
Roche.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

Board quality

supplier
markings

ACCU-CHEK®
Active

07124287

2 x 50

TEST STRIPS
5 second test

TIRAS-TESTE
Medição em 5 segundos



REF 07124287033
Barcode
4 015630 064236

Close/Re-cap container tightly
Immediately after removing
strips.

Depois de retirar a tira-teste,
fechar o frasco muito bem
imediatamente.

Тест-полоски «Акку-Чек Актив»
(Accu-Chek Active), 100 шт.
Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2008/01205 от 11.07.2022
Производитель, изготовитель:
«Рош Диабетс Кел ГмбХ», Зандхофер Штрассе
116, 68305, Мангайм, Германия
Сделано в Германии
Импортёр, уполномоченная организация
(представитель):
ООО «Рош Диагностика Рус»,
107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: 8-800-200-88-99
E-mail: info@accu-chek.ru

Уповноважений представник в Україні
ТОВ «Рош Україна»
Україна 04070, м. Київ,
вул. Петра Сагайдачного, 33
UA TR 116 E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com
Виробник: «Рош Диабетс Кел ГмбХ», Зандхофер
Штрассе 116, 68305, Мангайм, Германия
www.accu-chek.com

Sản xuất tại Đức

09387692001(04)
080x044x080 H

Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), 100 шт. – макет маркировки на русском языке

Тест-полоски "Акку-Чек Актив"

(Accu-Chek Active), 100 шт.

Регистрационное удостоверение:

№ ФСЗ 2008/01205 от _____

Производитель, изготовитель:

"Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Сандхофер

Штрассе 116, 68305, Мангейм, Германия

Сделано в Германии

Импортер, уполномоченная организация (претензии):

ООО «Рош Диагностика Рус»,

107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: 8-800-200-88-99

E-mail: info@accu-chek.ru

Кат.номер: 07124287033 RU_097_XX_V2

Всего пронумеровано,
протшнуровано и
скреплено печатью
10 листа (ов)

по доверенности
от 30.01.2023 г.

