


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЕАМЕД»
Е.Н. Истомова
Истомова Е.Н.
«*26*» *август* 2024



Фотографические изображения медицинского изделия


Ретикулоцитарный реагент А500-РР
для гематологических анализаторов АВАКОР
по ТУ 21.20.23-010-45399867-2020

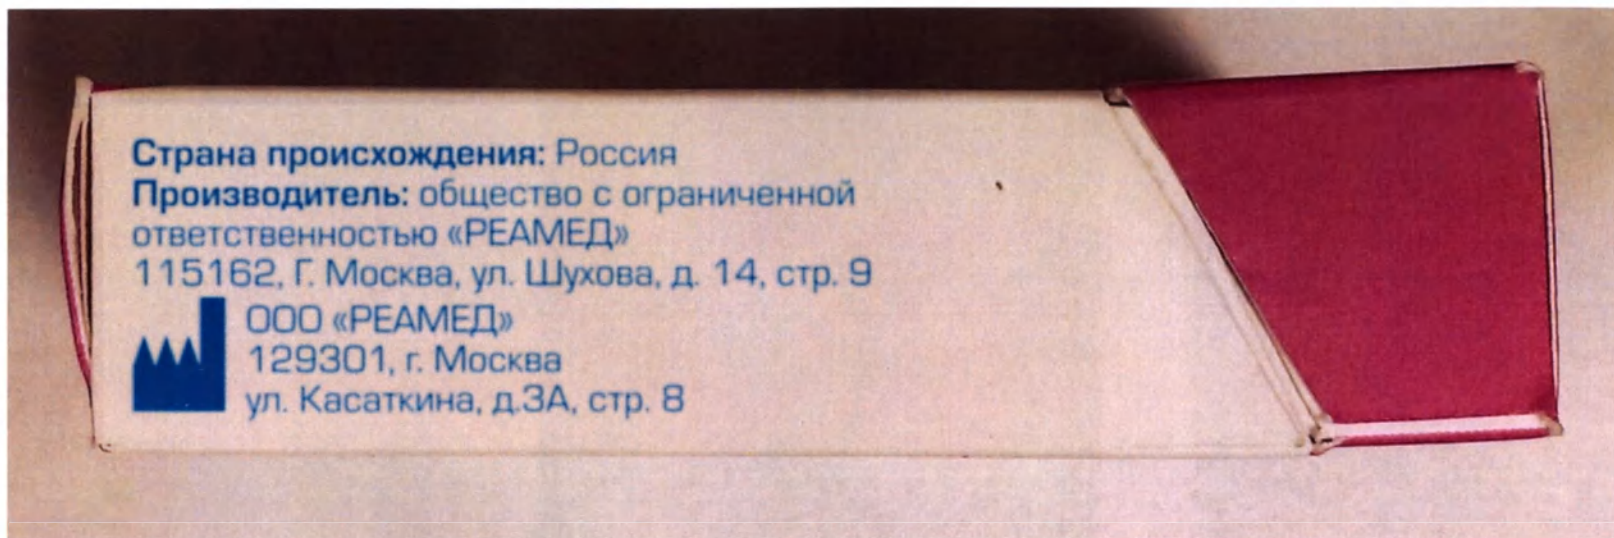

Упаковка
Пачка 3 шт по 4мл

ТУ 21.20.23-010-45399867-2020

РУ XXX№ XXXXXXXXXXXX



не замораживать

**Ретикулоцитарный реагент
A500-PP для гематологических
анализаторов АВАКОР**



**для in vitro
диагностики**



В случае контакта с кожей немедленно
промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и при
проглатывании немедленно обратиться
к врачу

Количество: 3 шт.

Основные ингредиенты:

Хлорид натрия

< 3%

Буфер

< 0,5%

Калий щавеливокислый

< 1%

Краситель

< 0,5%

Растворитель - вода

LOT XXXXX-XXX

REF XXXXX-XXX

 XX.XXXX

 XX.XXXX


 **3 теста**

для профессионального
применения


**Ретикулоцитарный реагент
A500-PP для гематологических
анализаторов АВАКОР**

3 пробирки по 4мл


Пачка 10 шт по 4мл

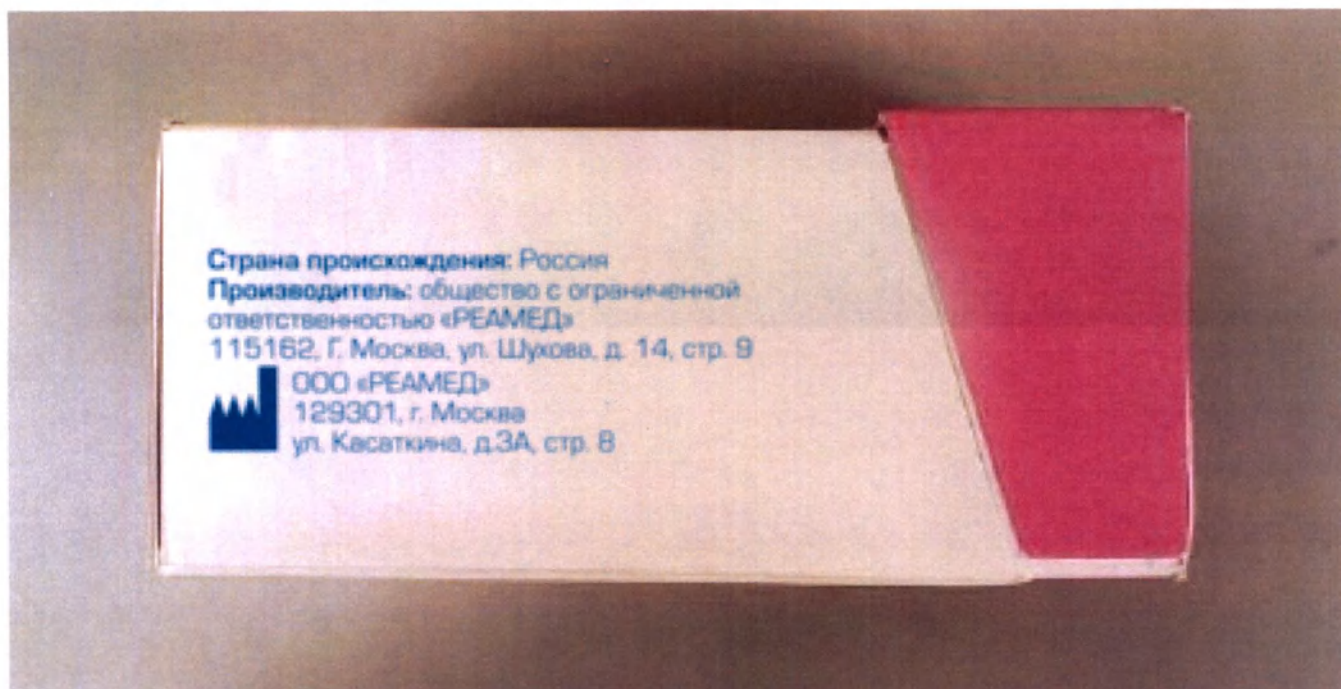



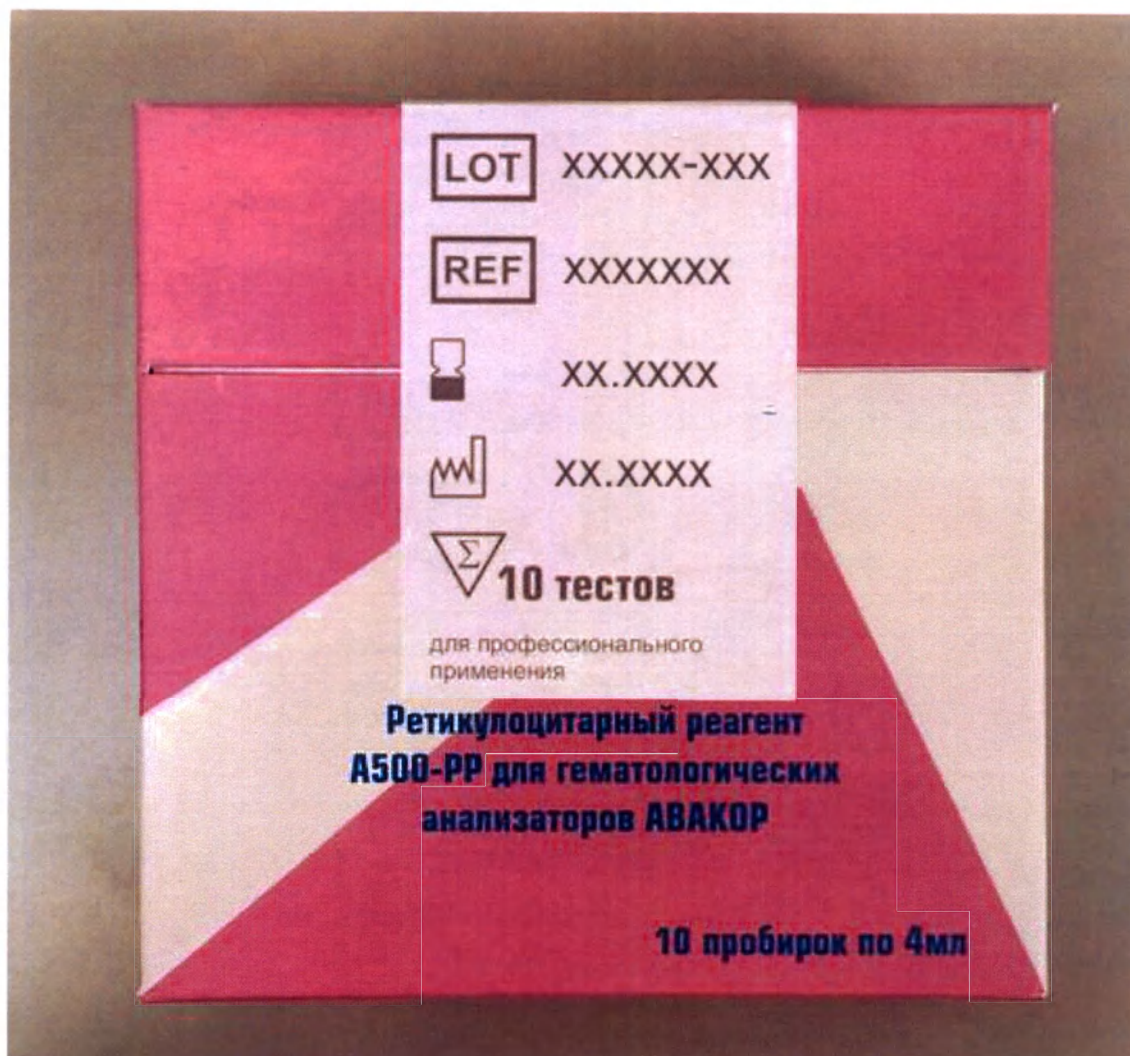

**Ретикулоцитарный реагент
A500-PP для гематологических
анализаторов АВАКОР**



**для in vitro
диагностики**



В случае контакта с кожей немедленно
промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и при
проглатывании немедленно обратиться
к врачу

Количество: 10 шт.

Основные ингредиенты:

Хлорид натрия	< 3%
Буфер	< 0,5%
Калий цитрат/лимоннокислый	< 1%
Краситель	< 0,5%
Растворитель - вода	


Ретикулоцитарный реагент, пробирка




Макеты этикеток

Этикетка пробирки	Этикетка пачки
35,00 мм Ретикулоцитарный реагент А500-РР для гематологических анализаторов АВАКОР LOT 012021-501 02.2023 02.2021 IVD 4мл ООО «РЕАМЕД» ТУ 21.20.23-010-45399867-2020 РУ XXX№ XXXXXXXXXXXX 55,00 мм	LOT REF 3 теста для профессионального применения

ровка пачки на 3 пробирки:

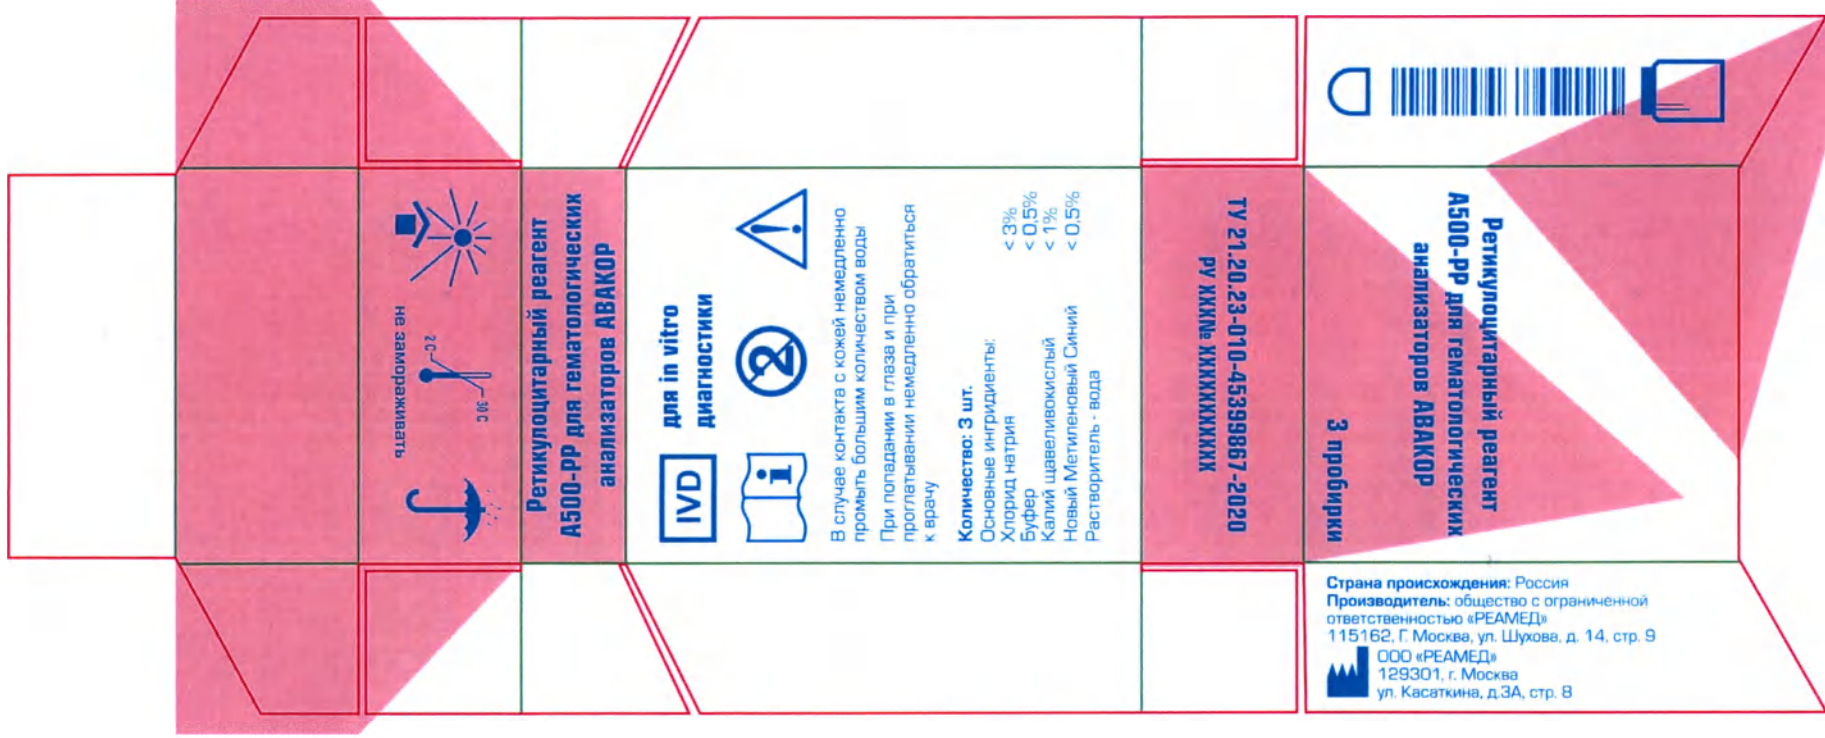

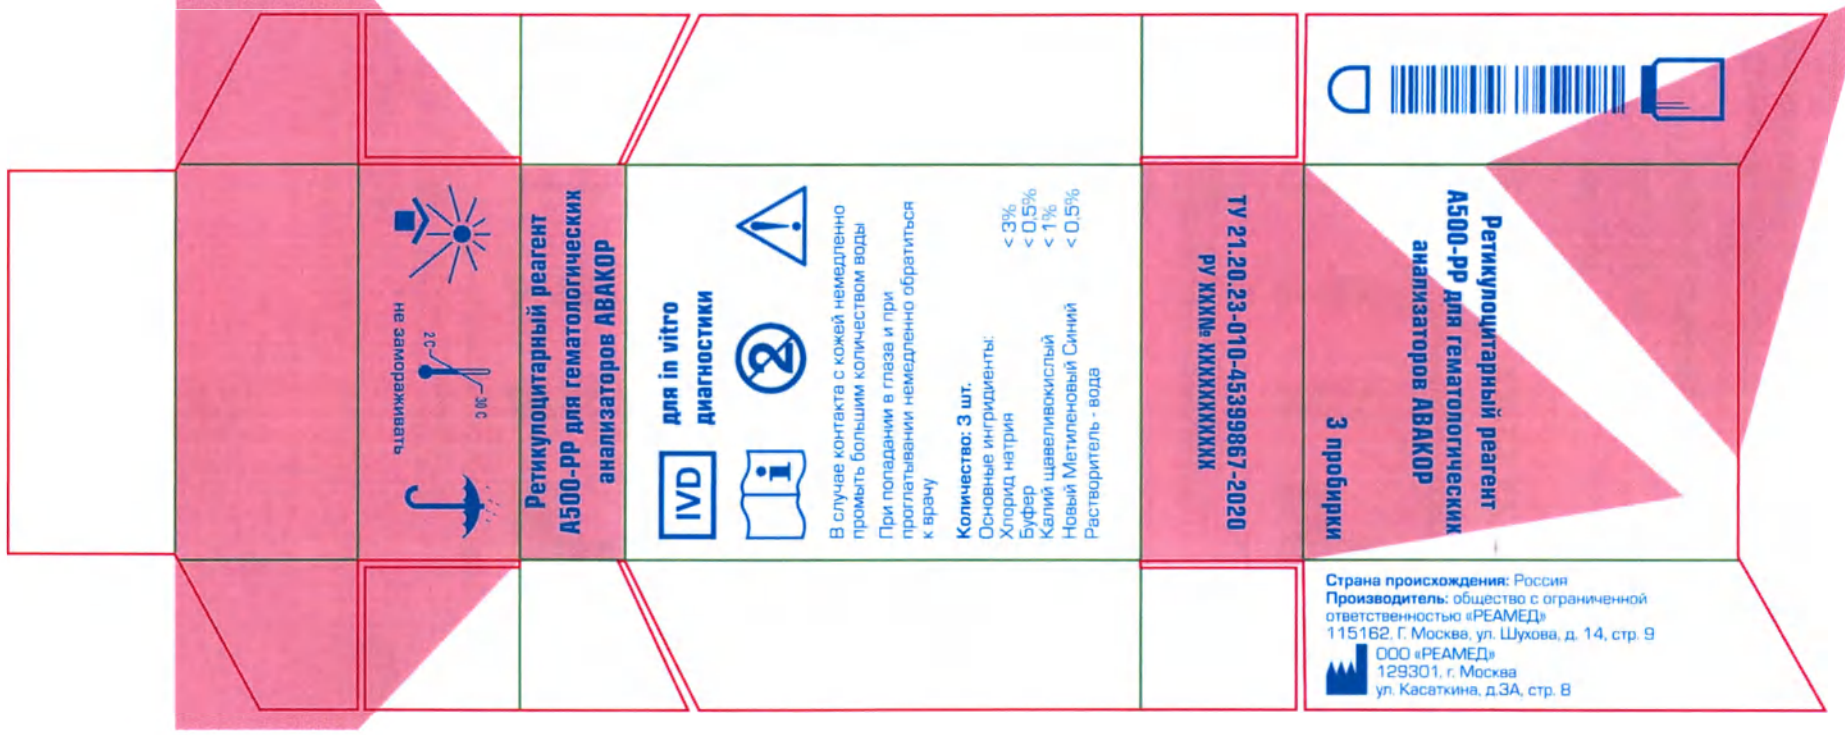

**Ретикулоцитарный реагент А500-РР
для гематологических анализаторов АВАКОР**

брутто	XX.X кг	пачка 3 пробирки по 4мл	XX шт.
нетто	XX.X кг	инструкция	XX шт.
нетто пачки	XXX г	паспорт	XX шт.

LOT XXXXXX-XXX	 XX.XXXX	 XX.XXXX
-----------------------	---	---

ТУ 21.20.23-010-45399867-2020 РУ XXX XXXX/XXXXXX




ООО «РЕАМЕД»
129301 г. Москва
ул. Касаткина
д. 3А стр. 8

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9, Тел.: +7 495 933-34-36, E.mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



**Ретикулоцитарный реагент А500-РР
для гематологических анализаторов АВАКОР**

брутто	XX.X кг	пачка 10 пробирки по 4мл	XX шт.
нетто	XX.X кг	инструкция	XX шт.
нетто пачки	XXX г	паспорт	XX шт.

LOT XXXXXX-XXX	 XX.XXXX	 XX.XXXX
-----------------------	---	---

ТУ 21.20.23-010-45399867-2020 РУ XXX XXXX/XXXXXX




ООО «РЕАМЕД»
129301 г. Москва
ул. Касаткина
д. 3А стр. 8

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»


115162, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9, Тел.: +7 495 933-34-36, E.mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Четырнадцать) листа(ов)

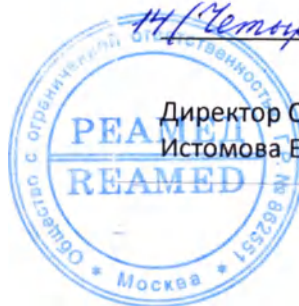

Директор ООО «РЕАМЕД»
Истомова Е.Н. *E. Istomova*