

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Грзан Групп»

Павлюков Ю.В.


2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)

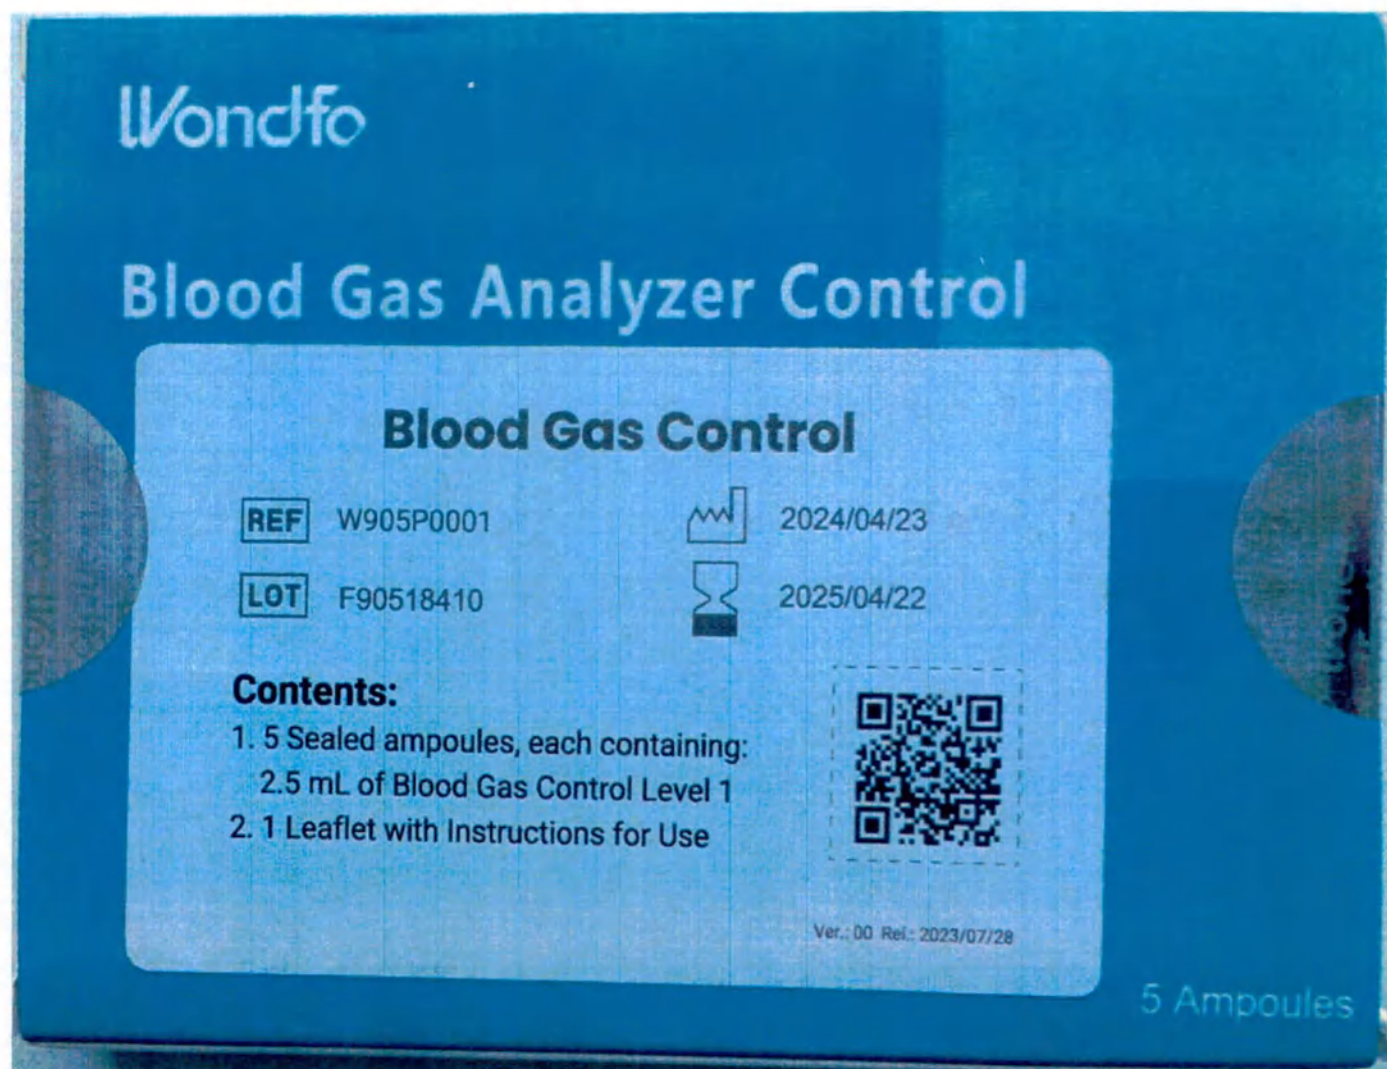


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)

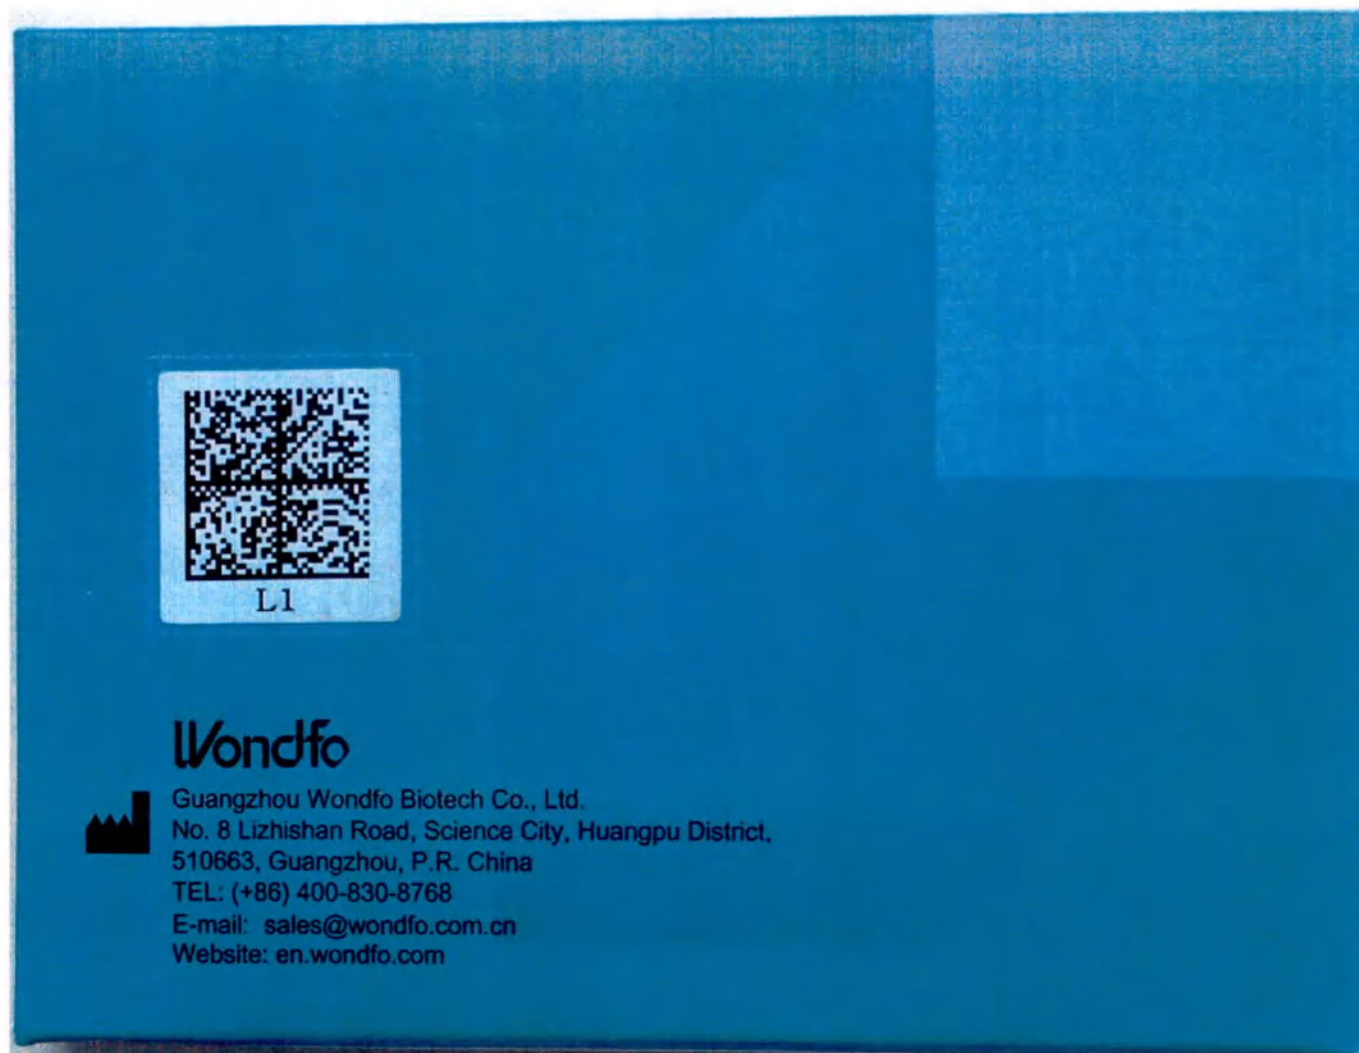

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)

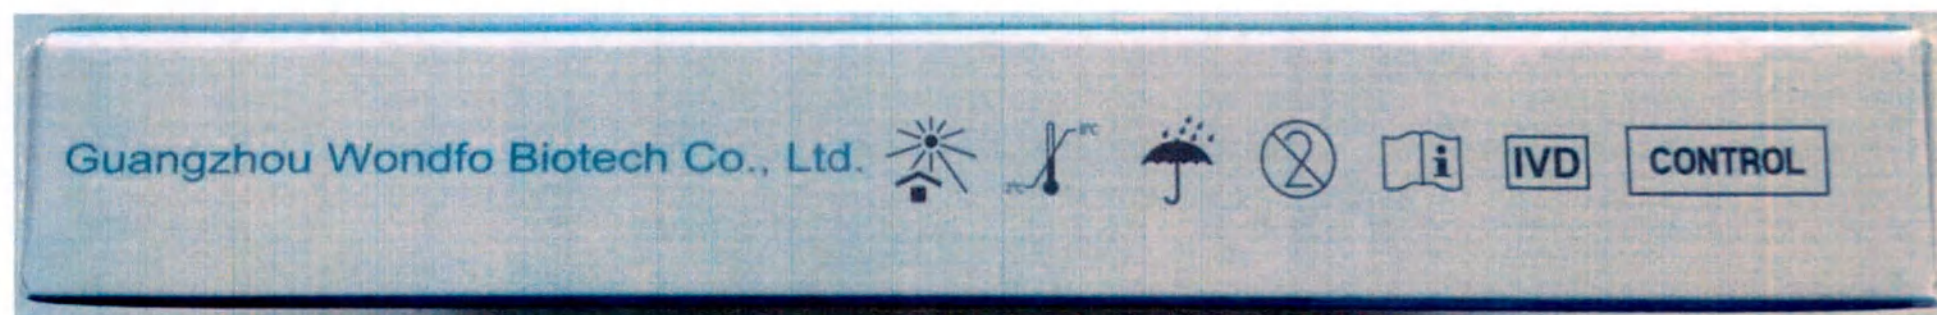

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)

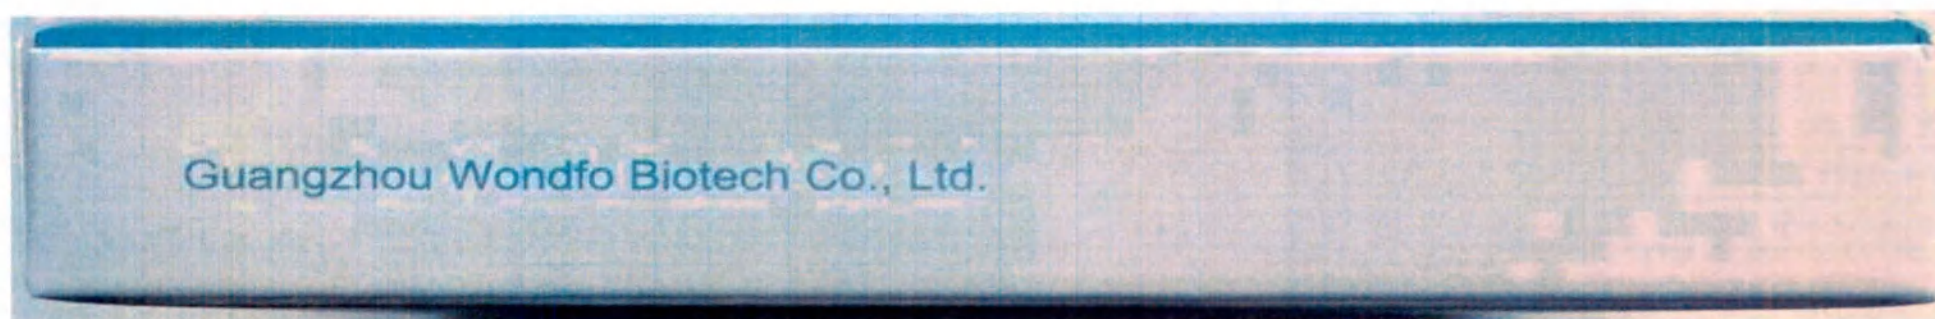

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)




Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1)




Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)

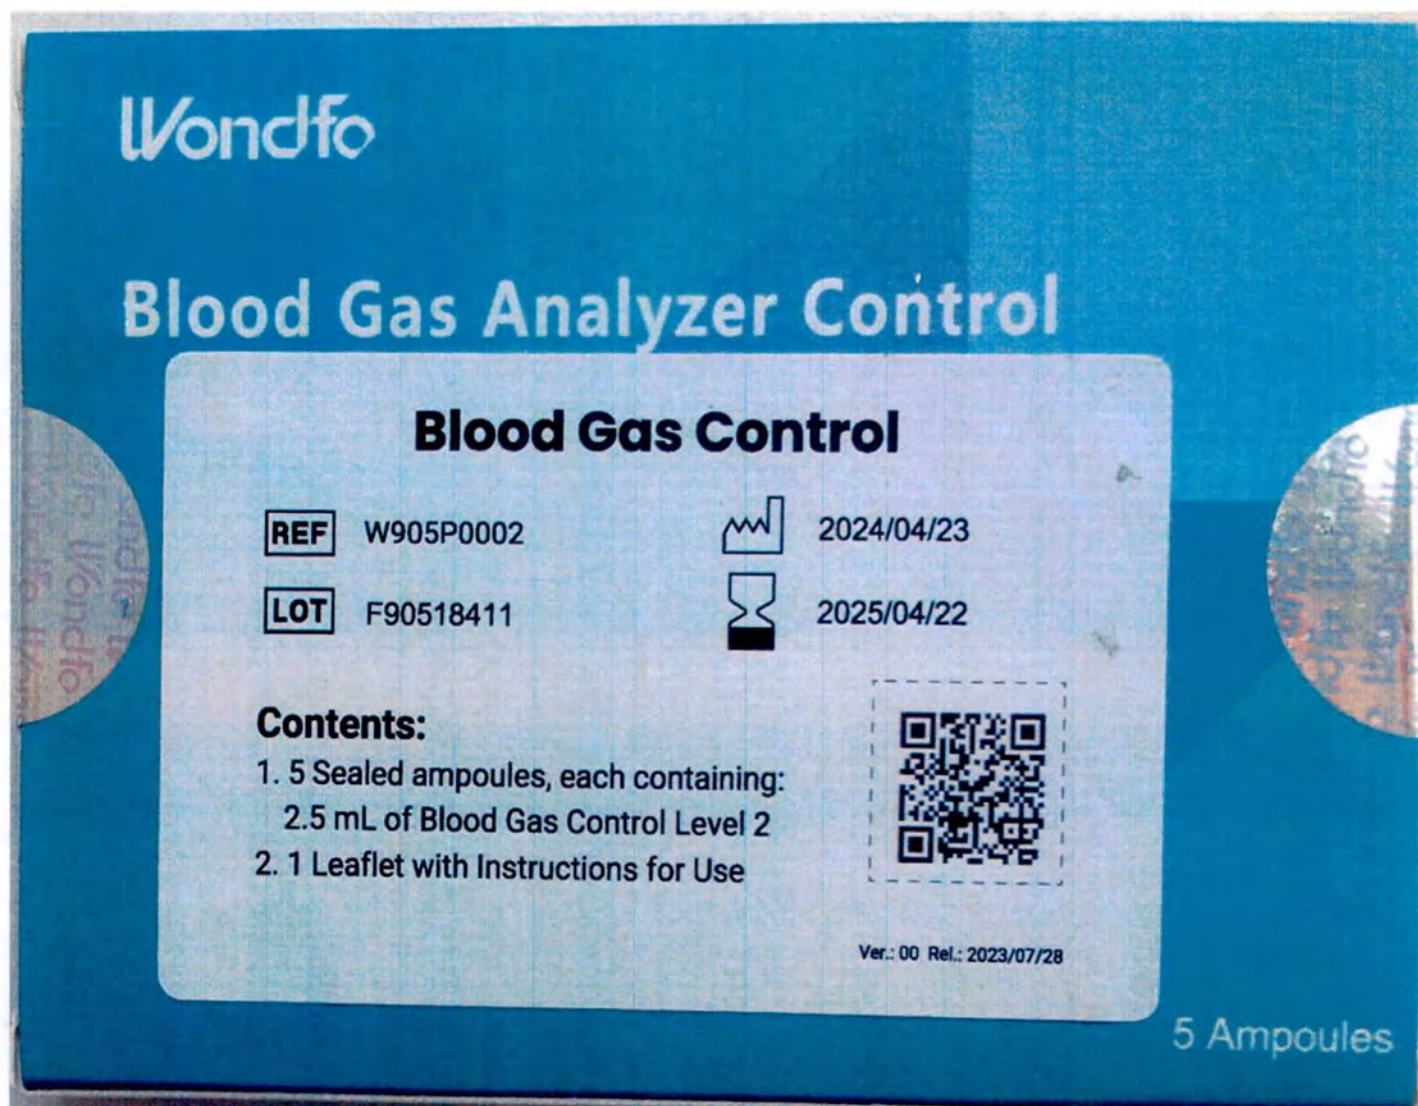


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)

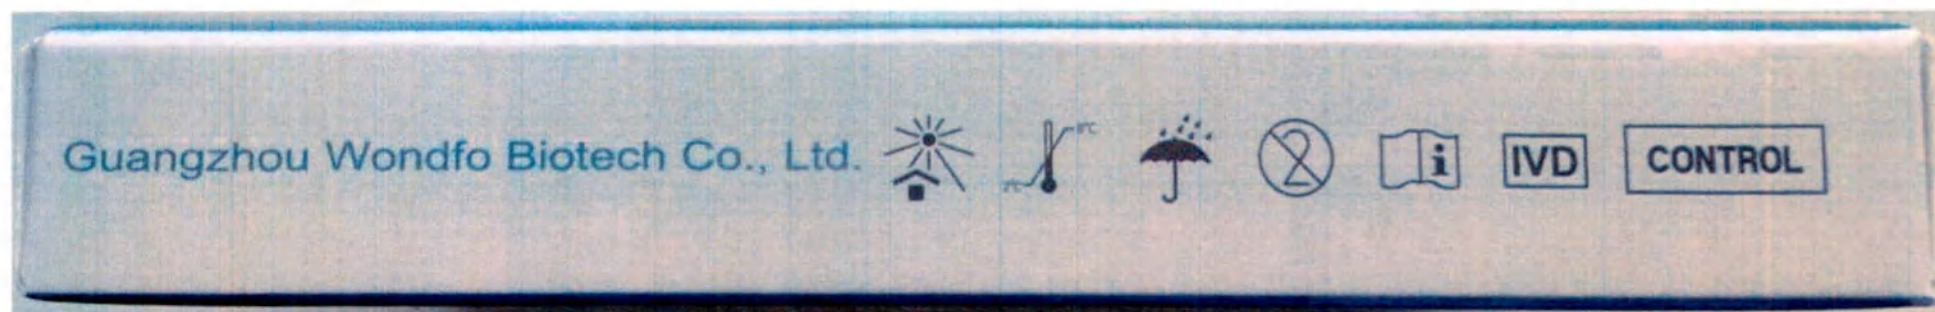

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)

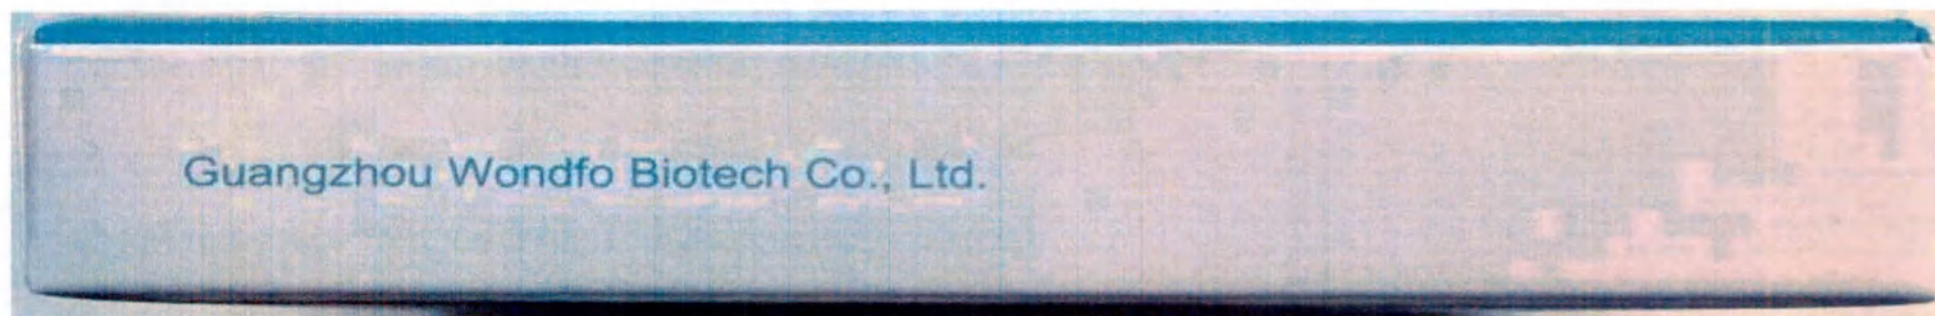


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)




Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 2)

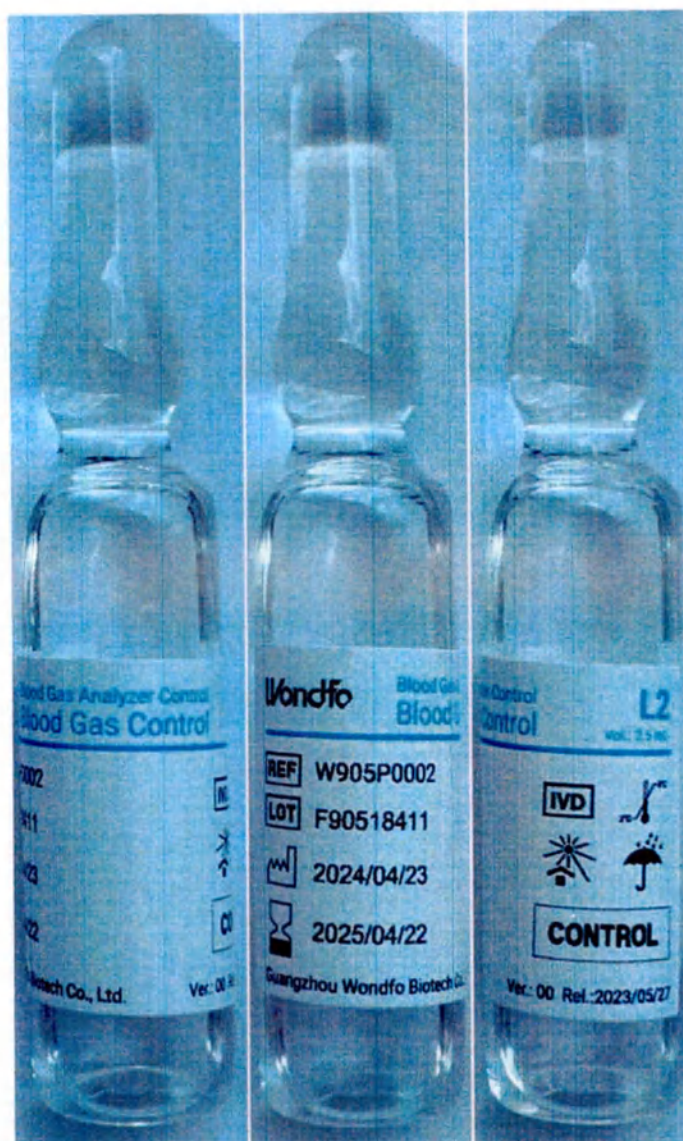

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)

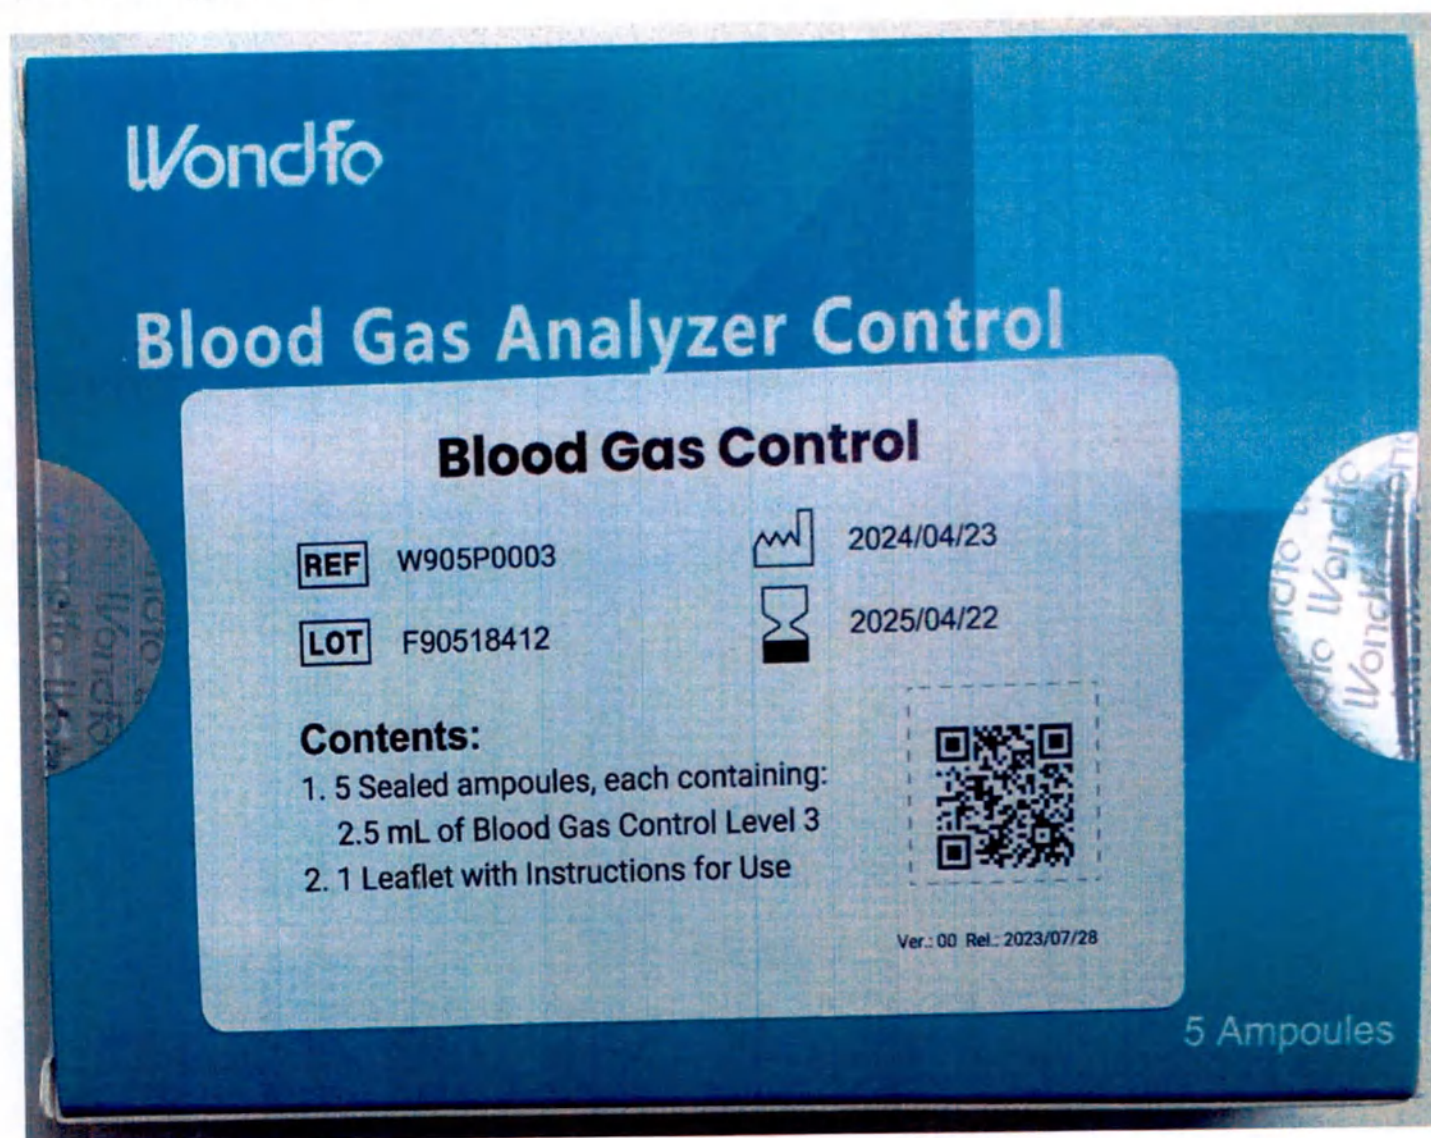

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)




Wondfo




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R. China
TEL: (+86) 400-830-8768
E-mail: sales@wondfo.com.cn
Website: en.wondfo.com


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)

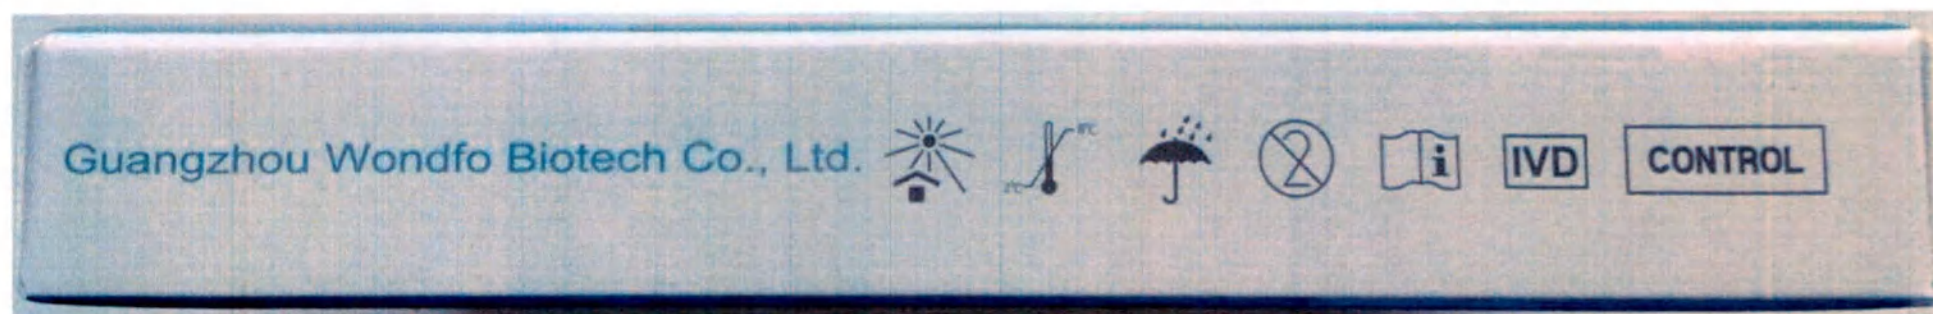


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)

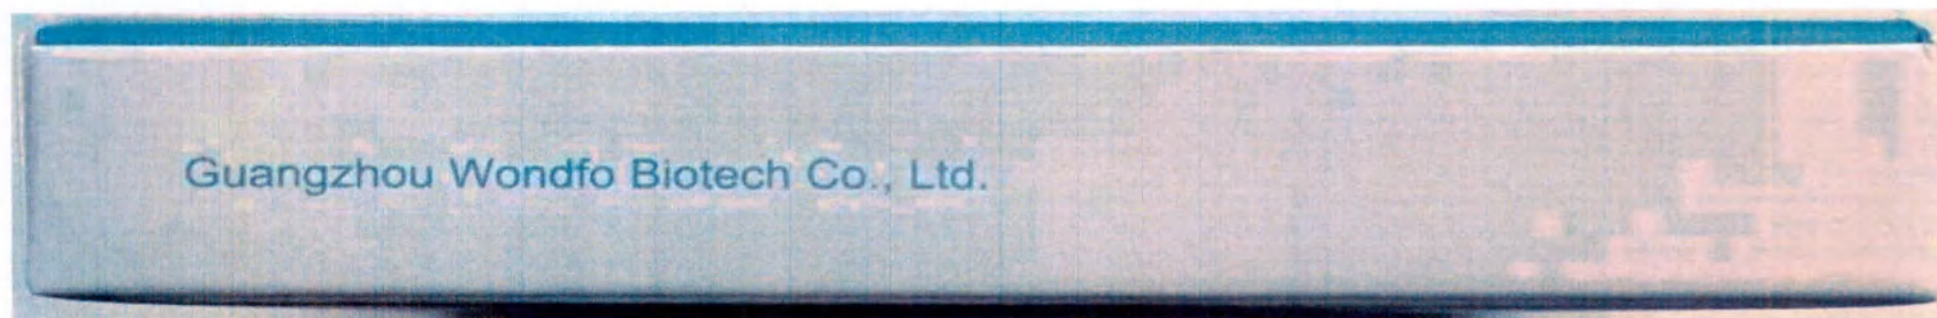

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)

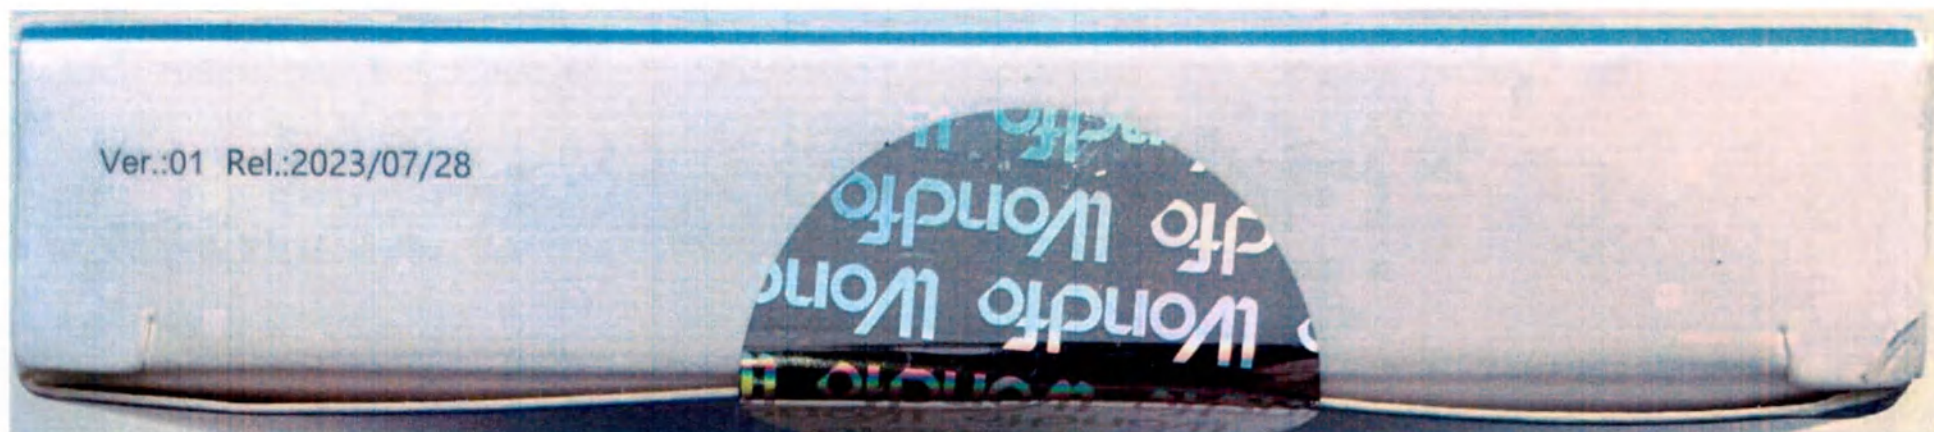


Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)

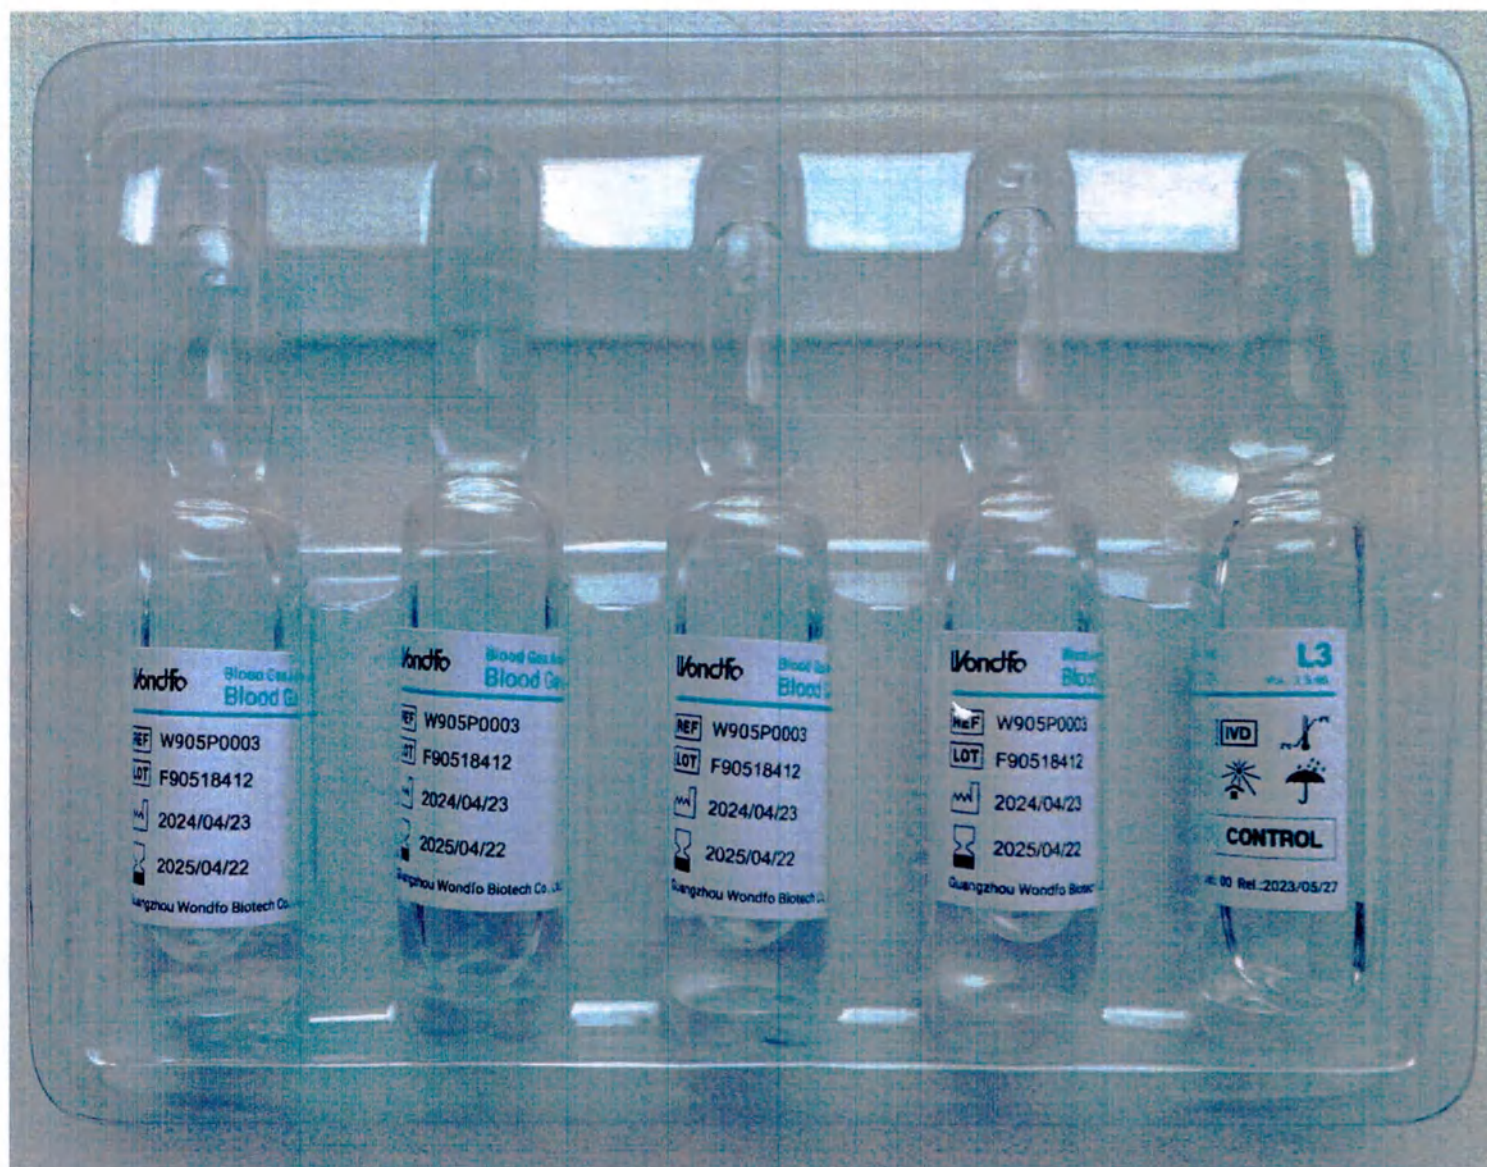

Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 3)



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 1)

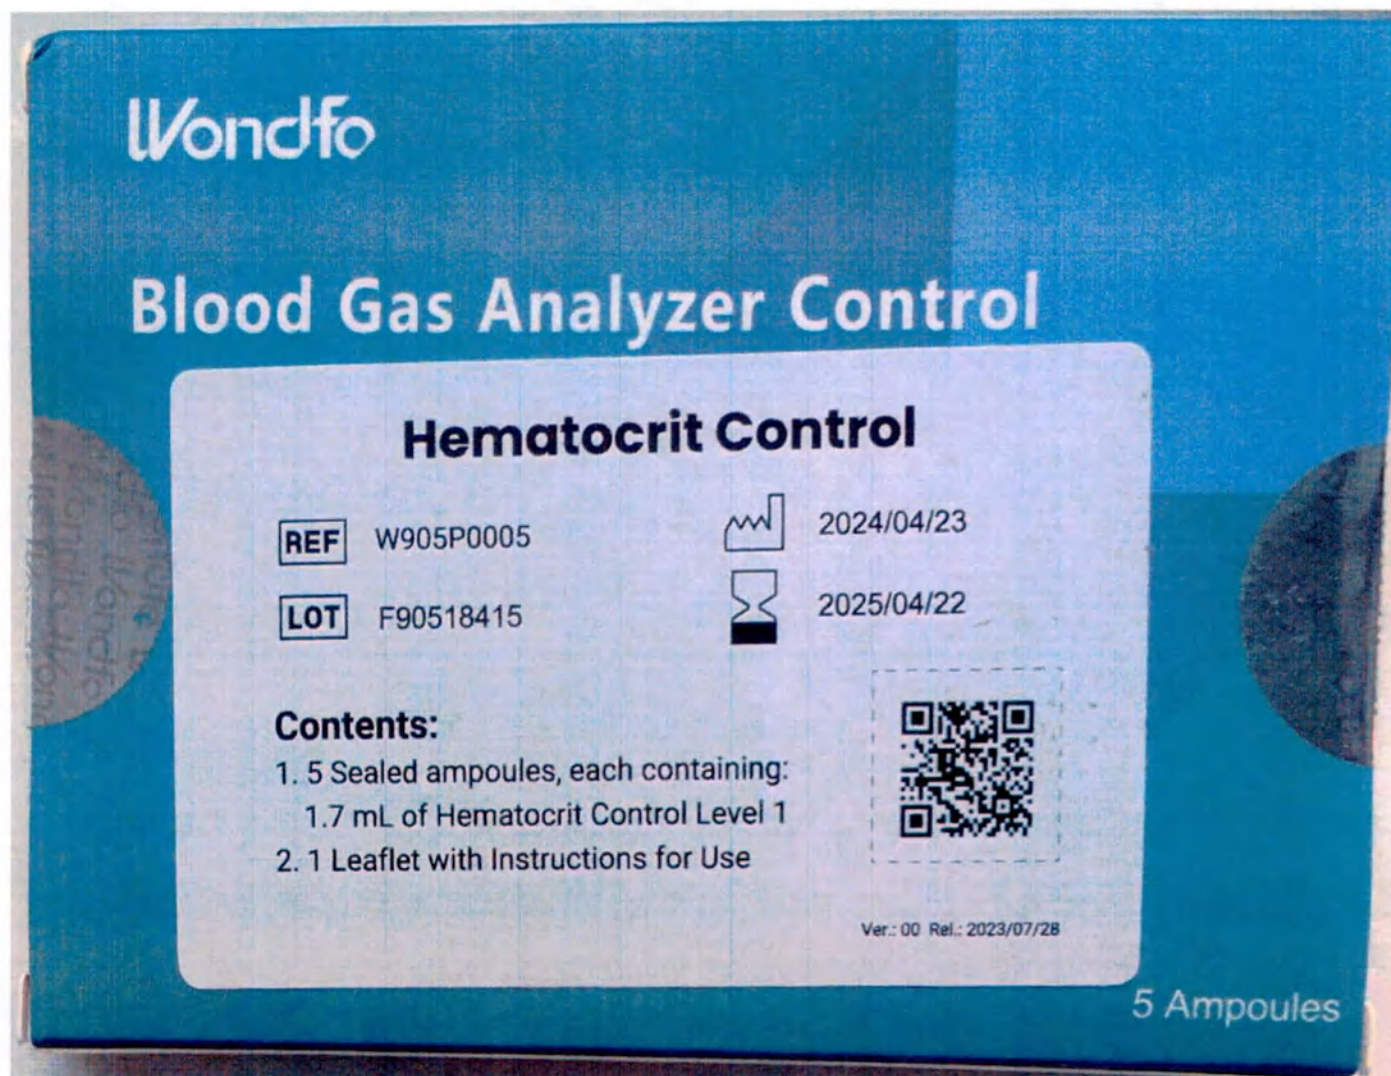

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров Hct (уровень 1)




Wondfo




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R. China
TEL: (+86) 400-830-8768
E-mail: sales@wondfo.com.cn
Website: en.wondfo.com

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 1)

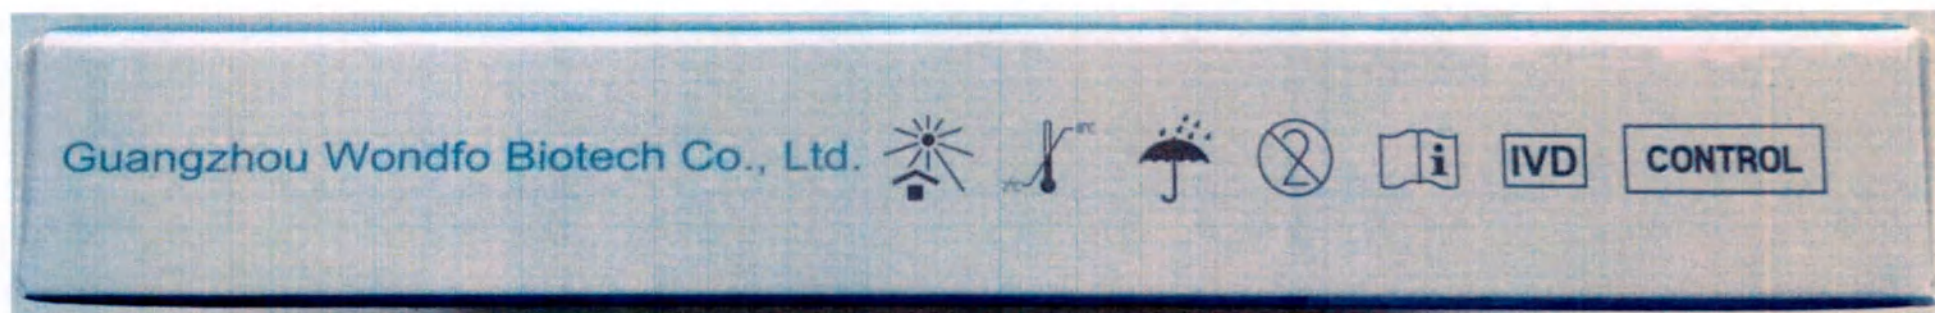

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров Hct (уровень 1)

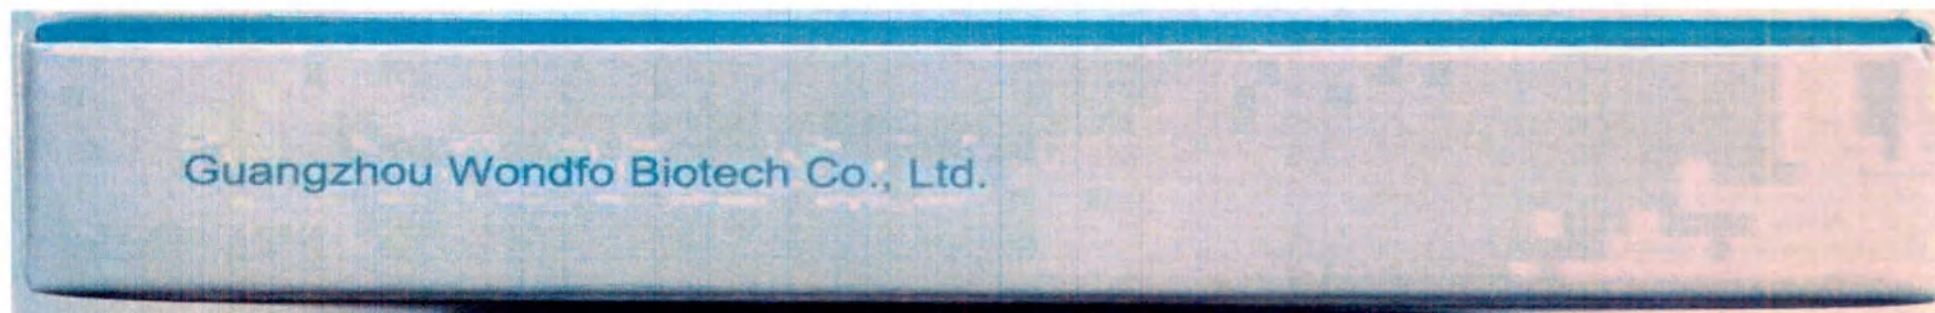

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 1)




Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 1)



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотного-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 1)



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 2)

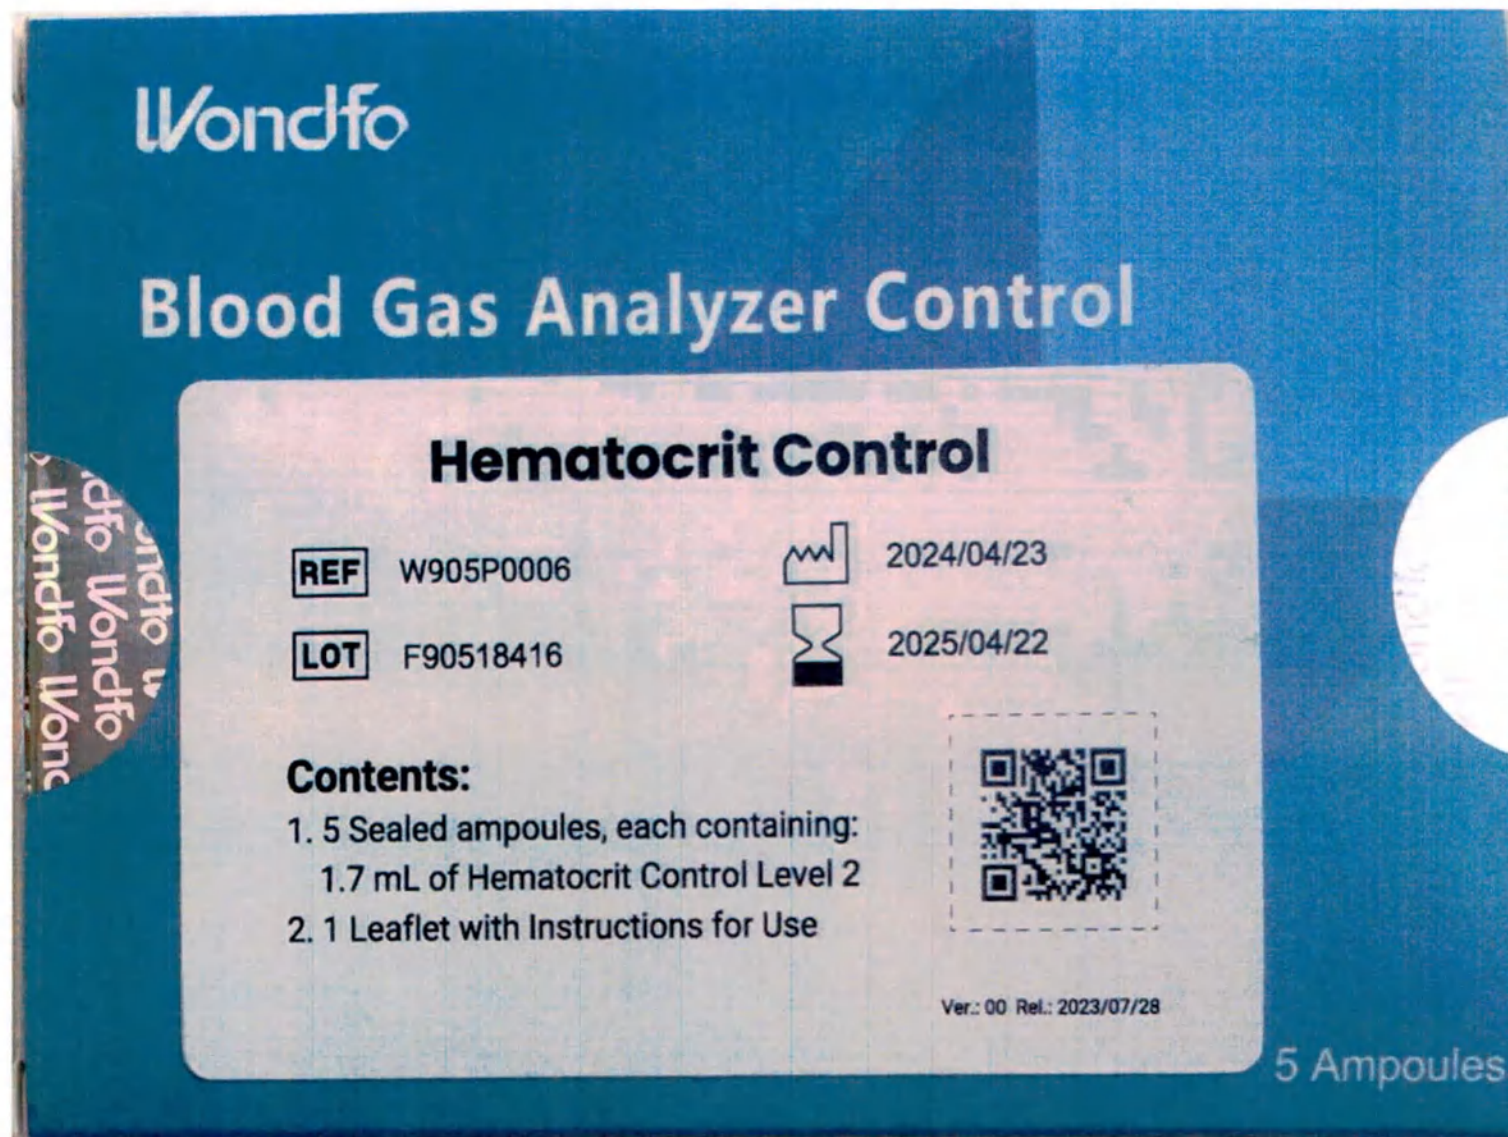

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров Hct (уровень 2)




HCT-L2

Wondfo




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R. China
TEL: (+86) 400-830-8768
E-mail: sales@wondfo.com.cn
Website: en.wondfo.com

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 2)

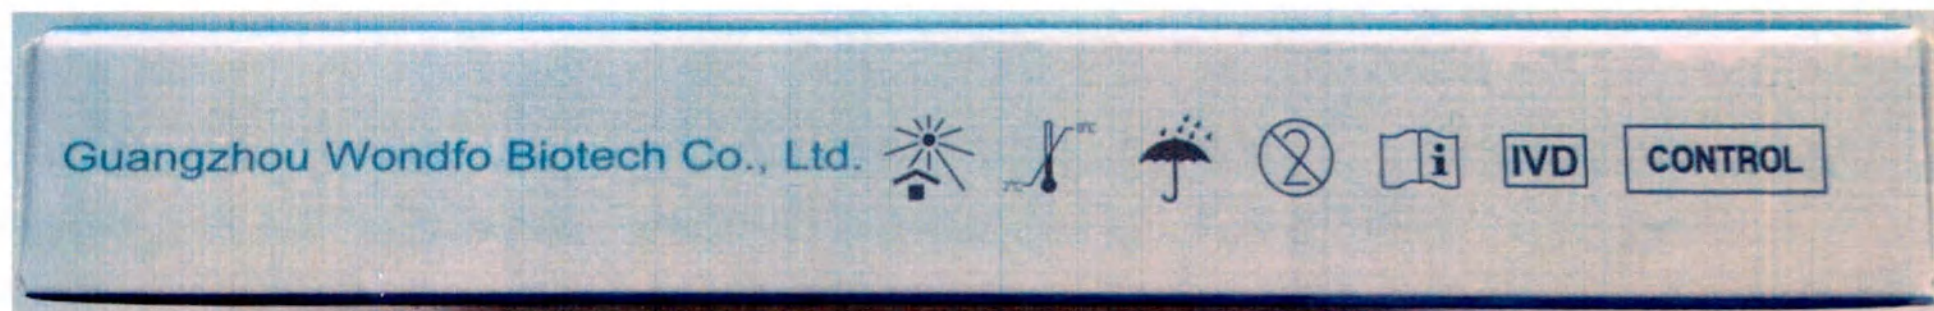

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров Hct (уровень 2)

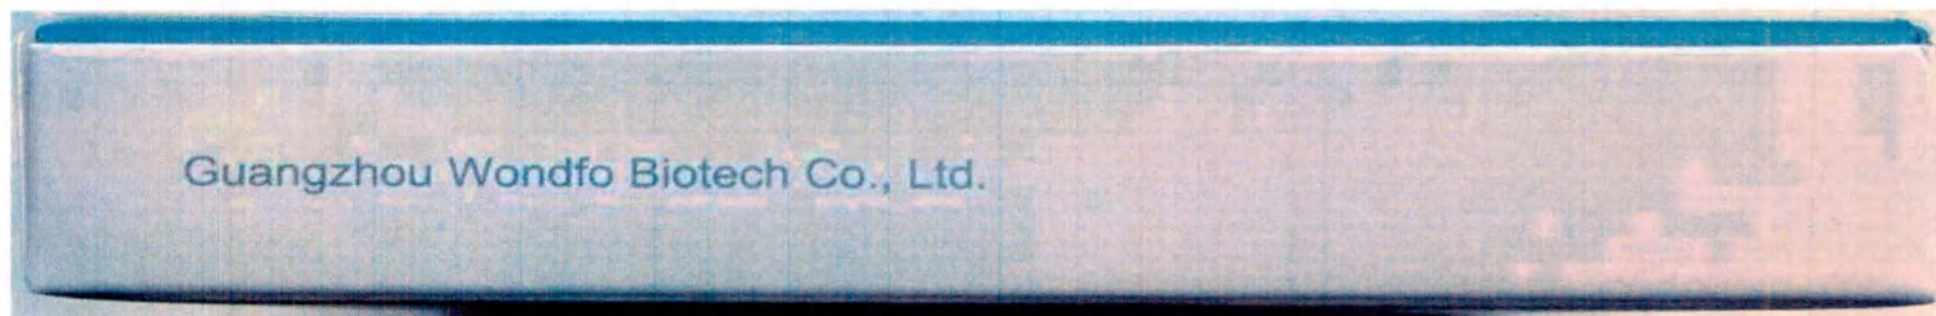


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 2)




Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 2)




Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров Hct (уровень 2)

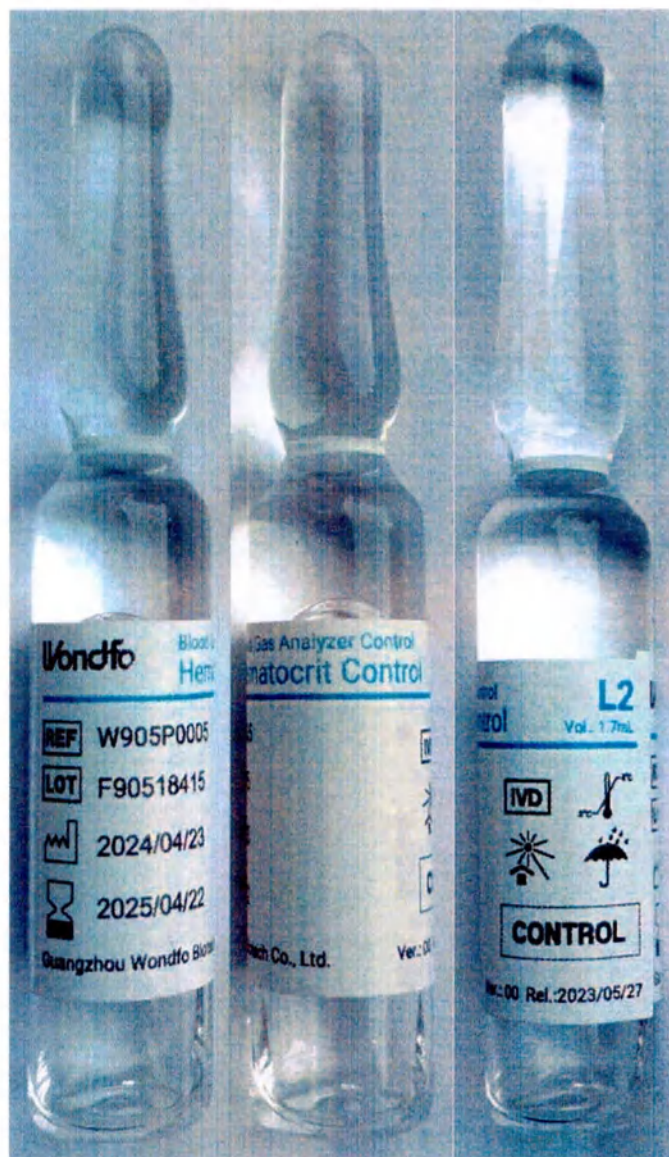


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3)

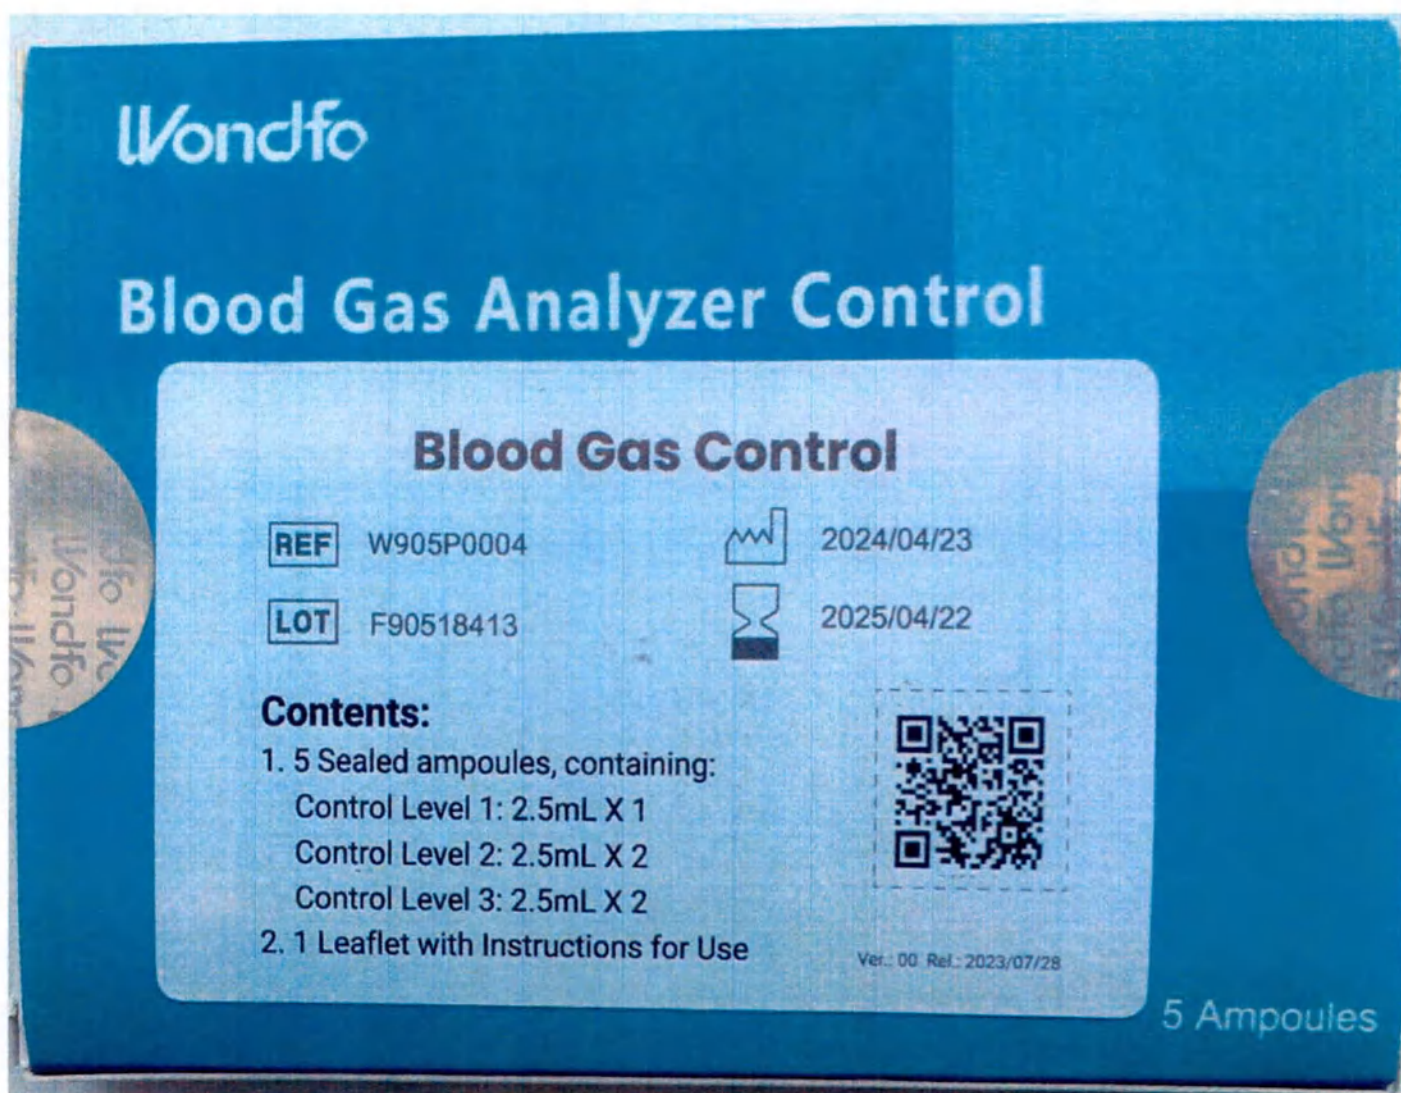


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3)

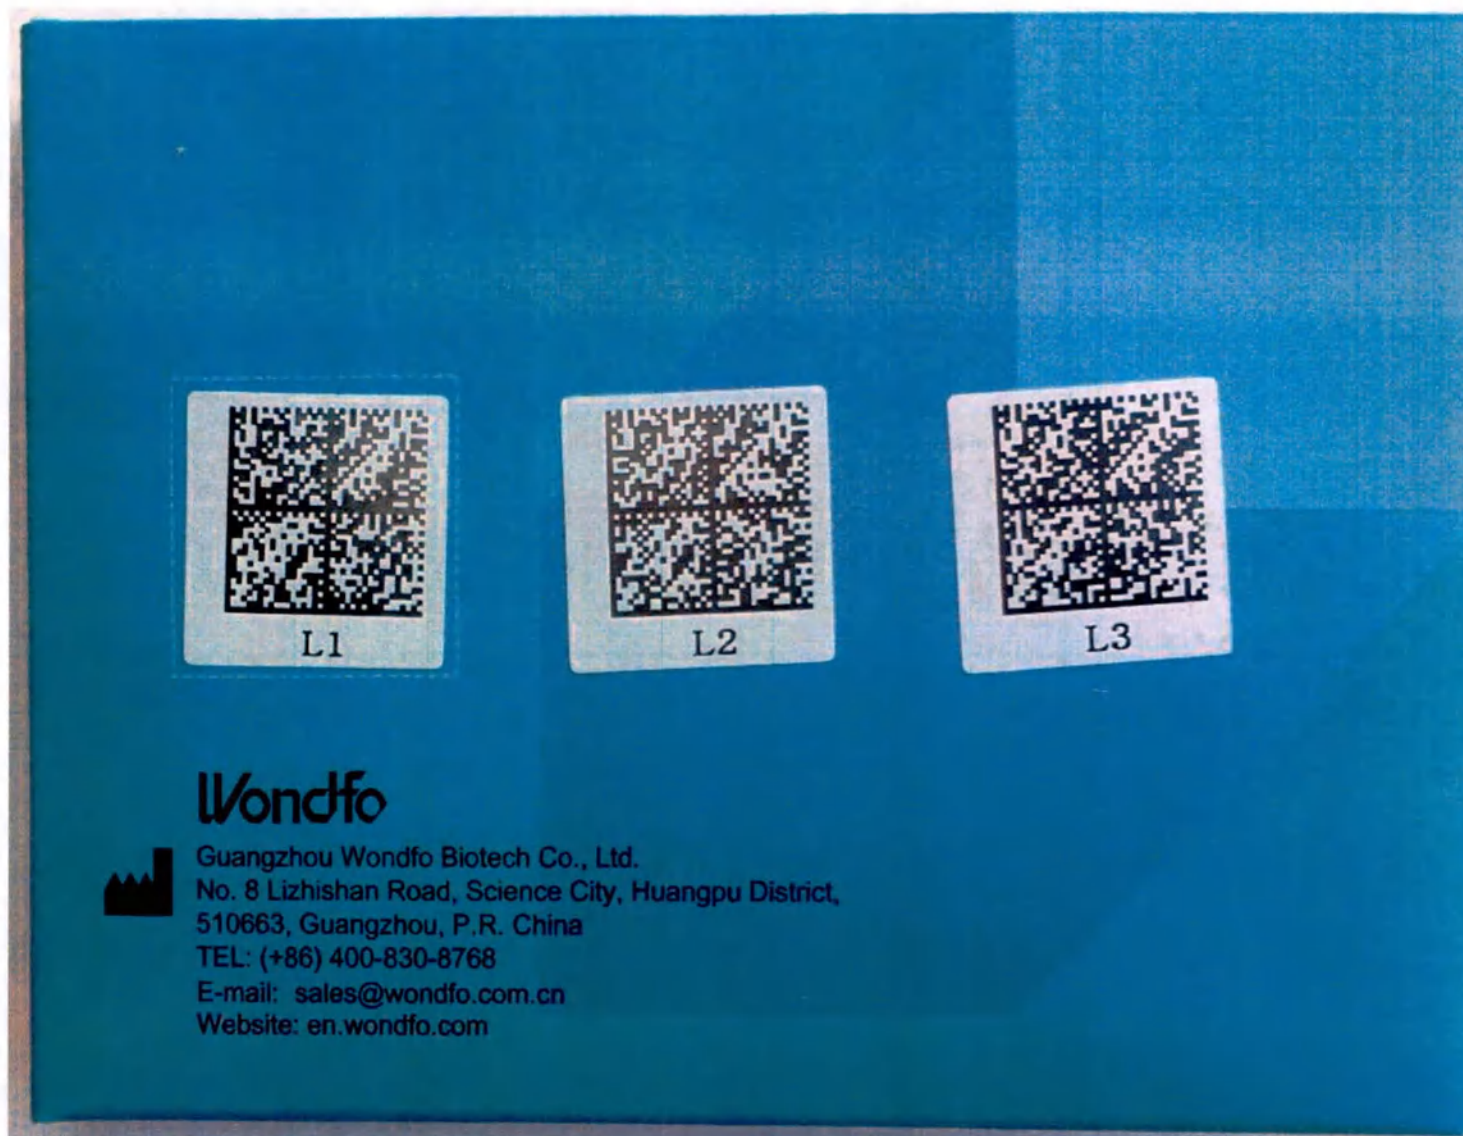

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac ((уровень 1/уровень 2 /уровень 3)

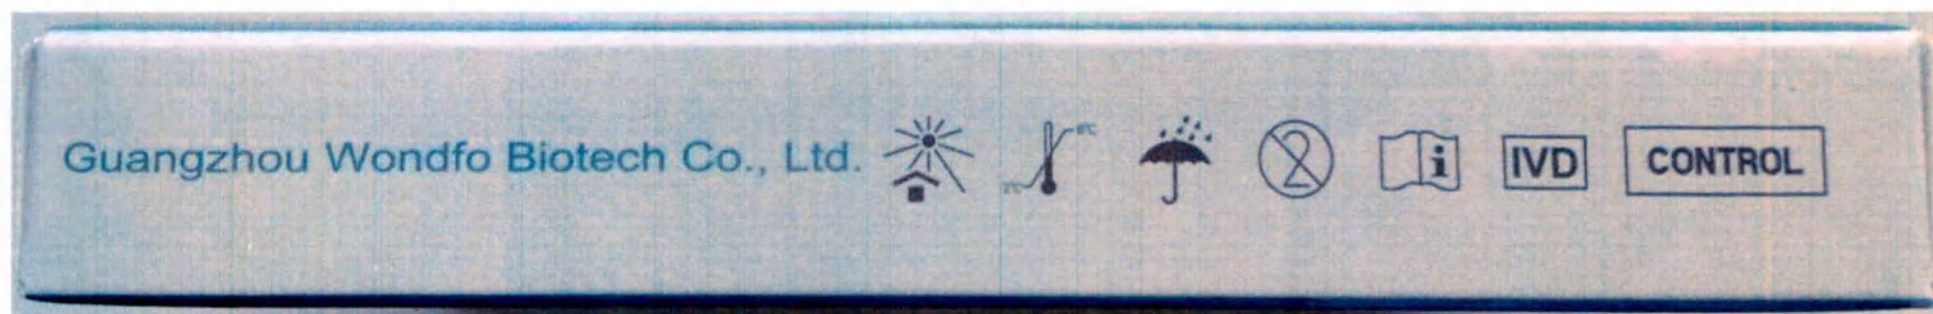

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3)

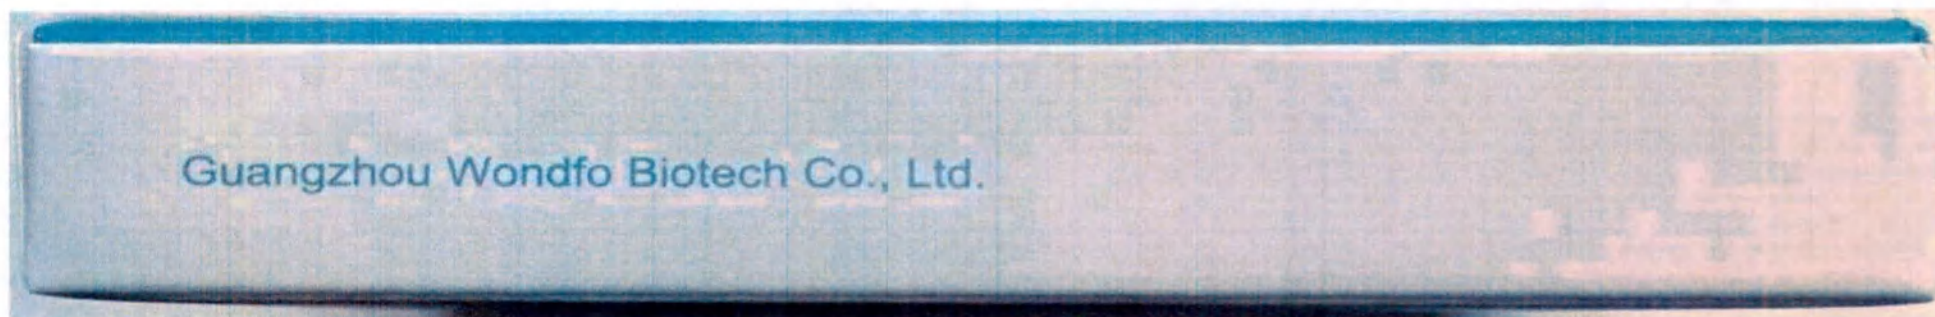

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3)



Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3)



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3) – Уровень 1




Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3) – Уровень 2




Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu и Lac (уровень 1/уровень 2 /уровень 3) – Уровень 3




Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)

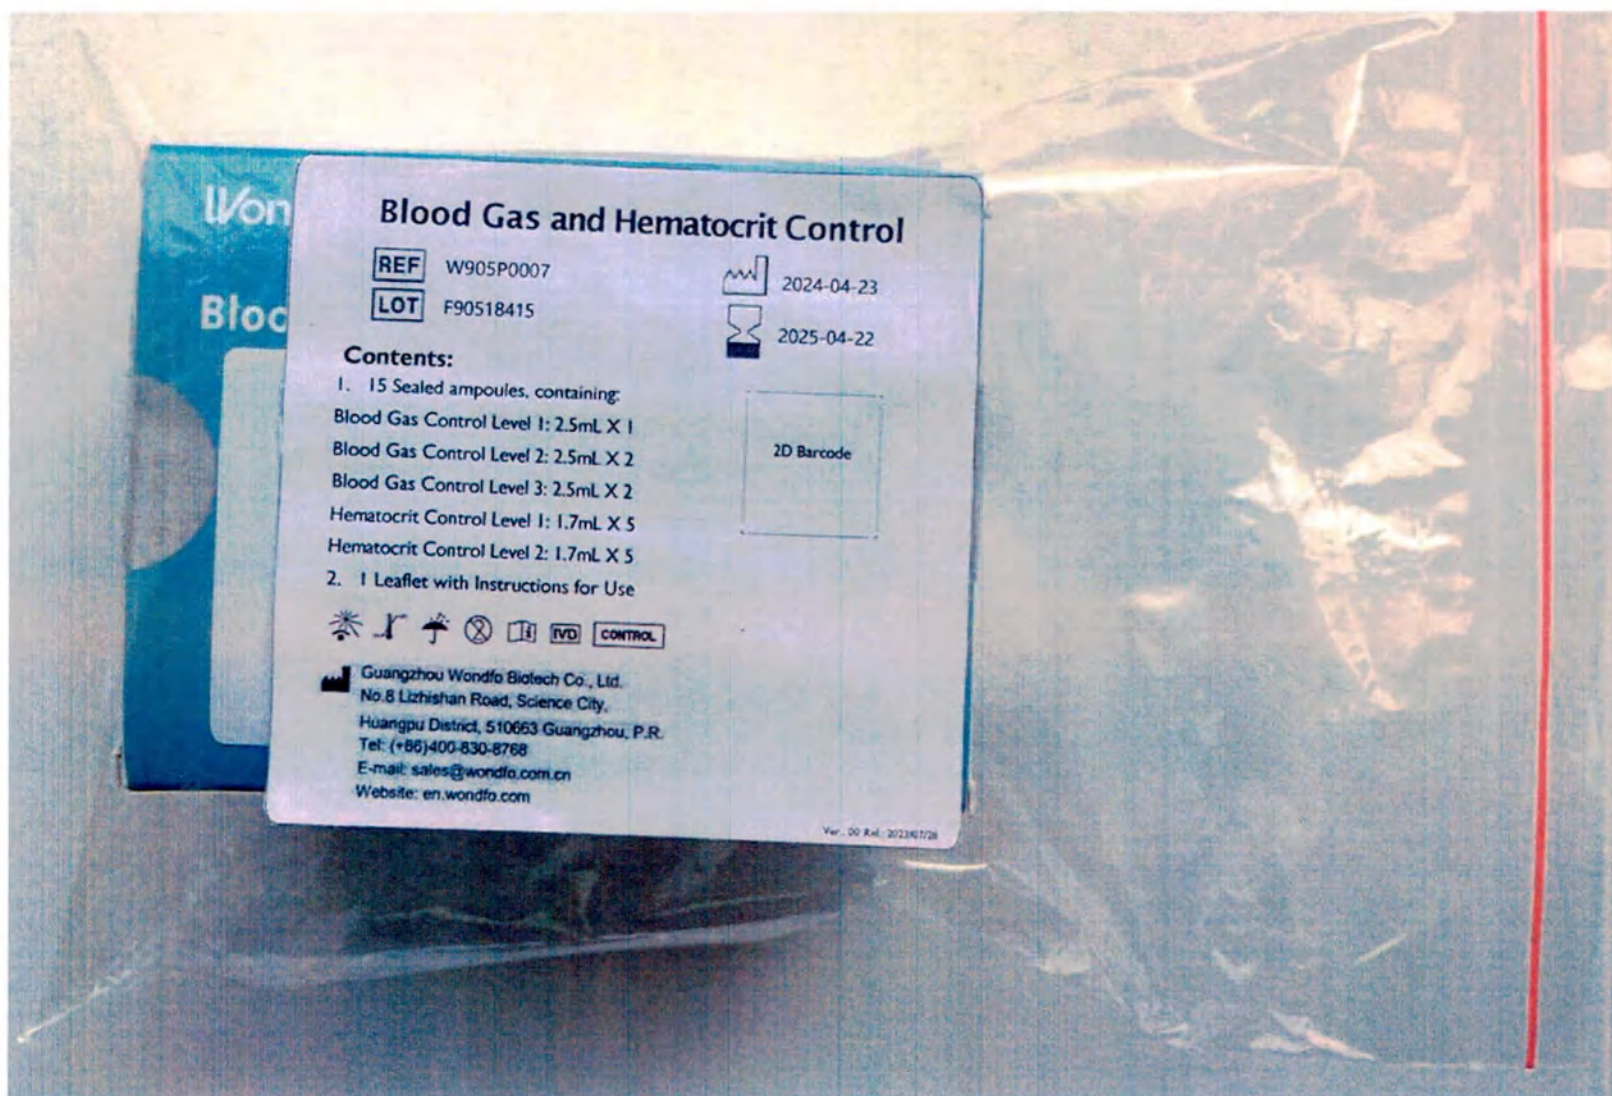


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2)

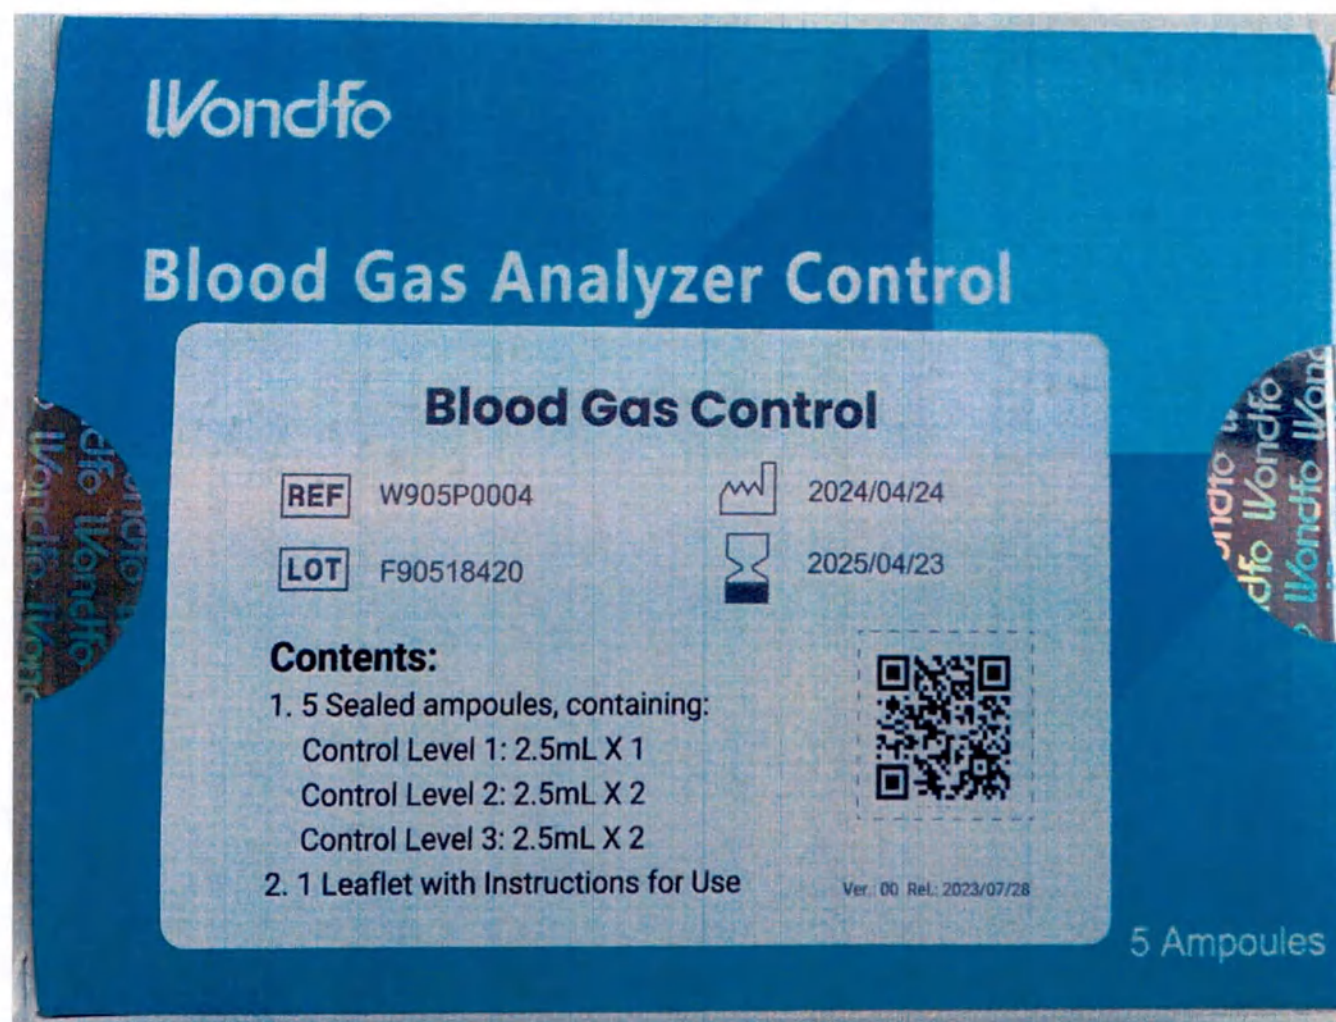


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)

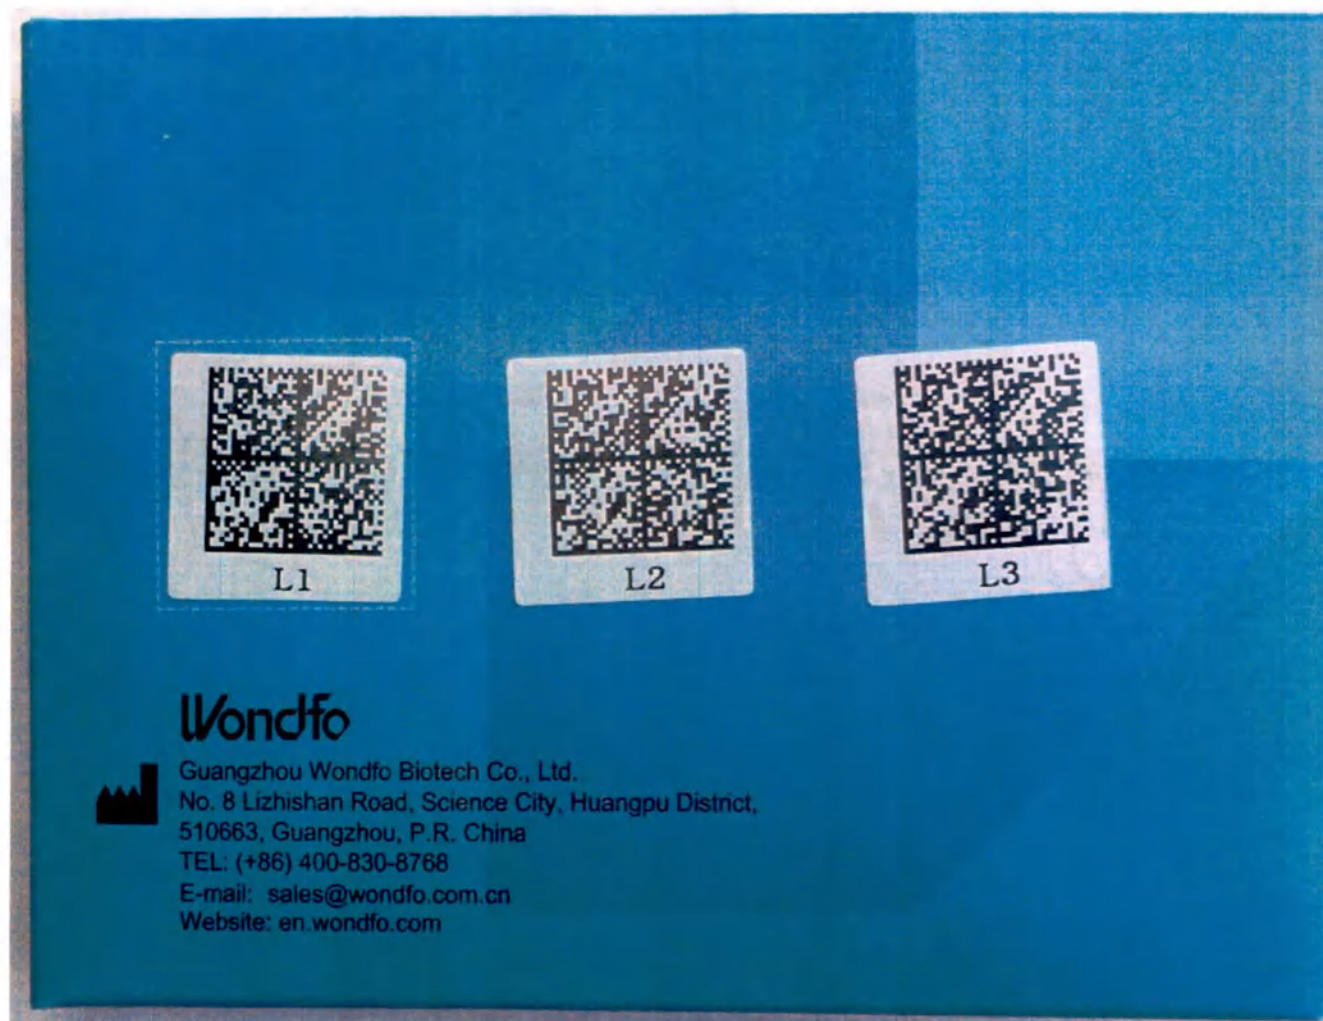


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)

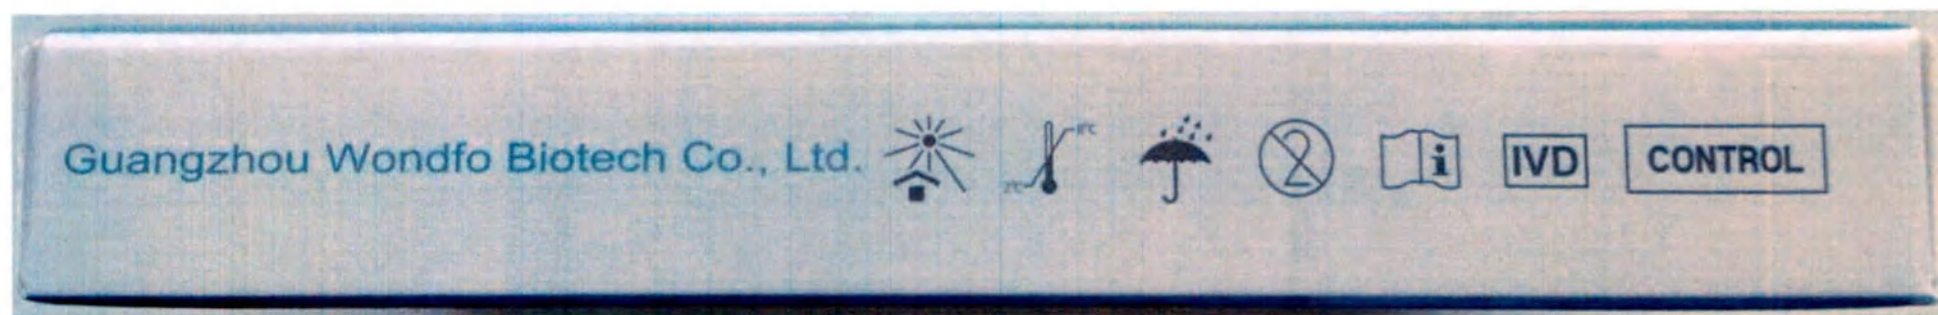

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку) варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2)

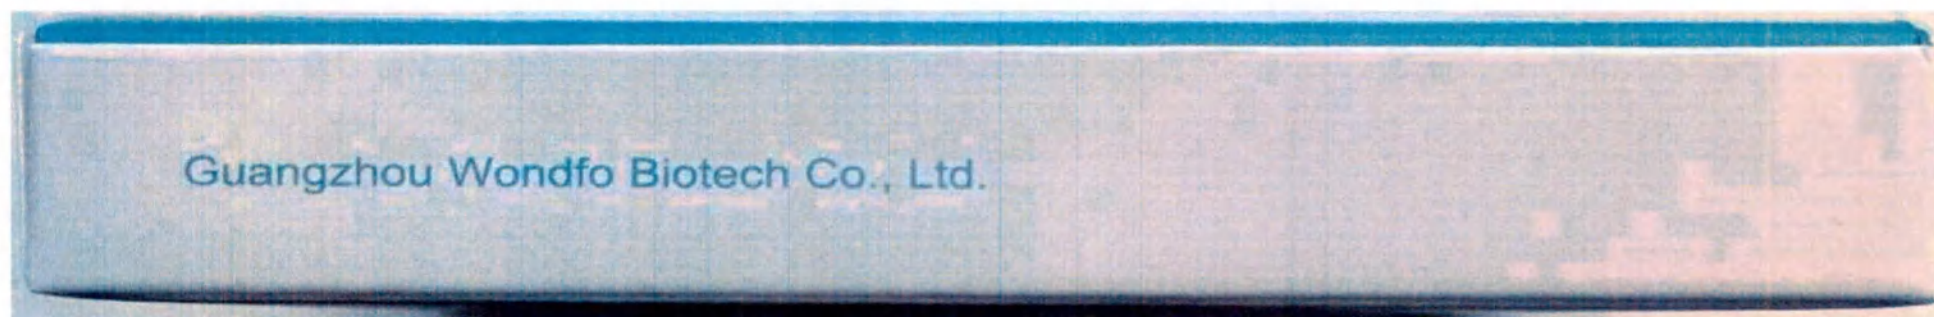


Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку компонента варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)

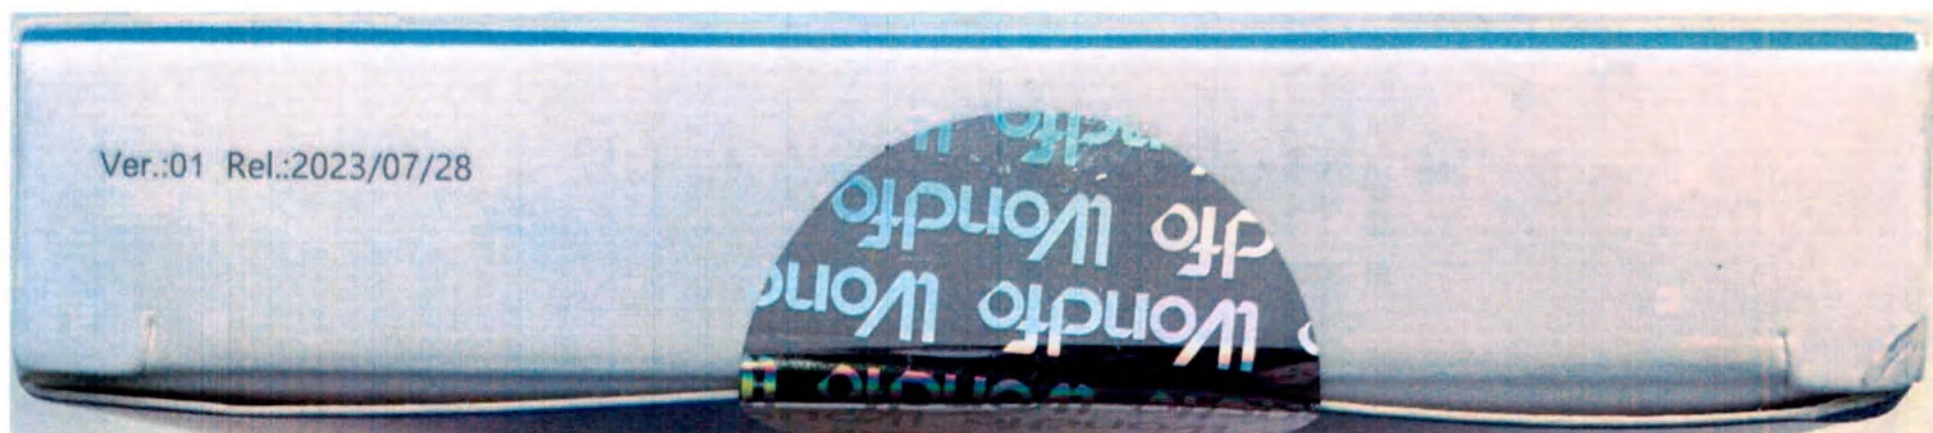

Внешний вид ампул компонента варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотнo-щелoчного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2)Уровень 1

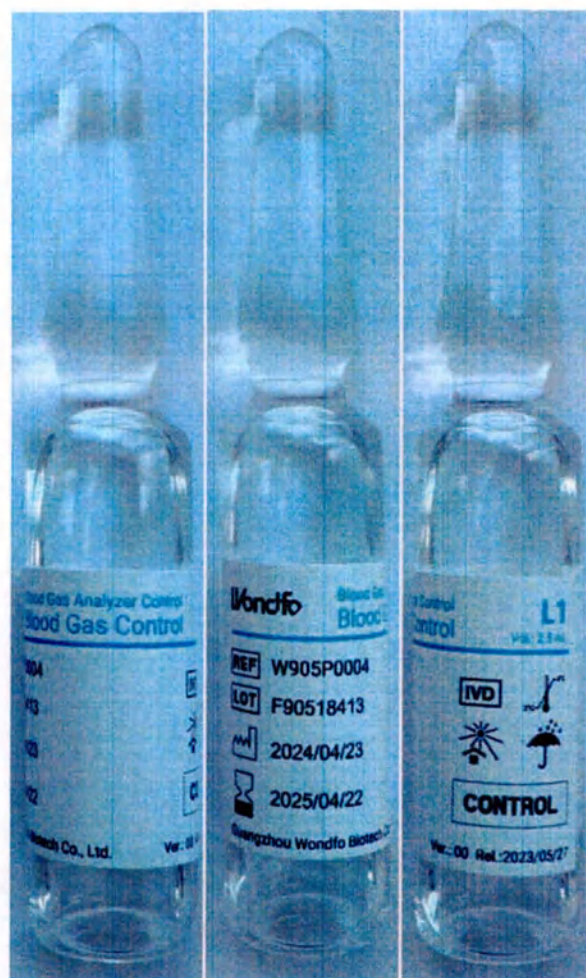


Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2)– Уровень 2



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2)) – Уровень 3



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1

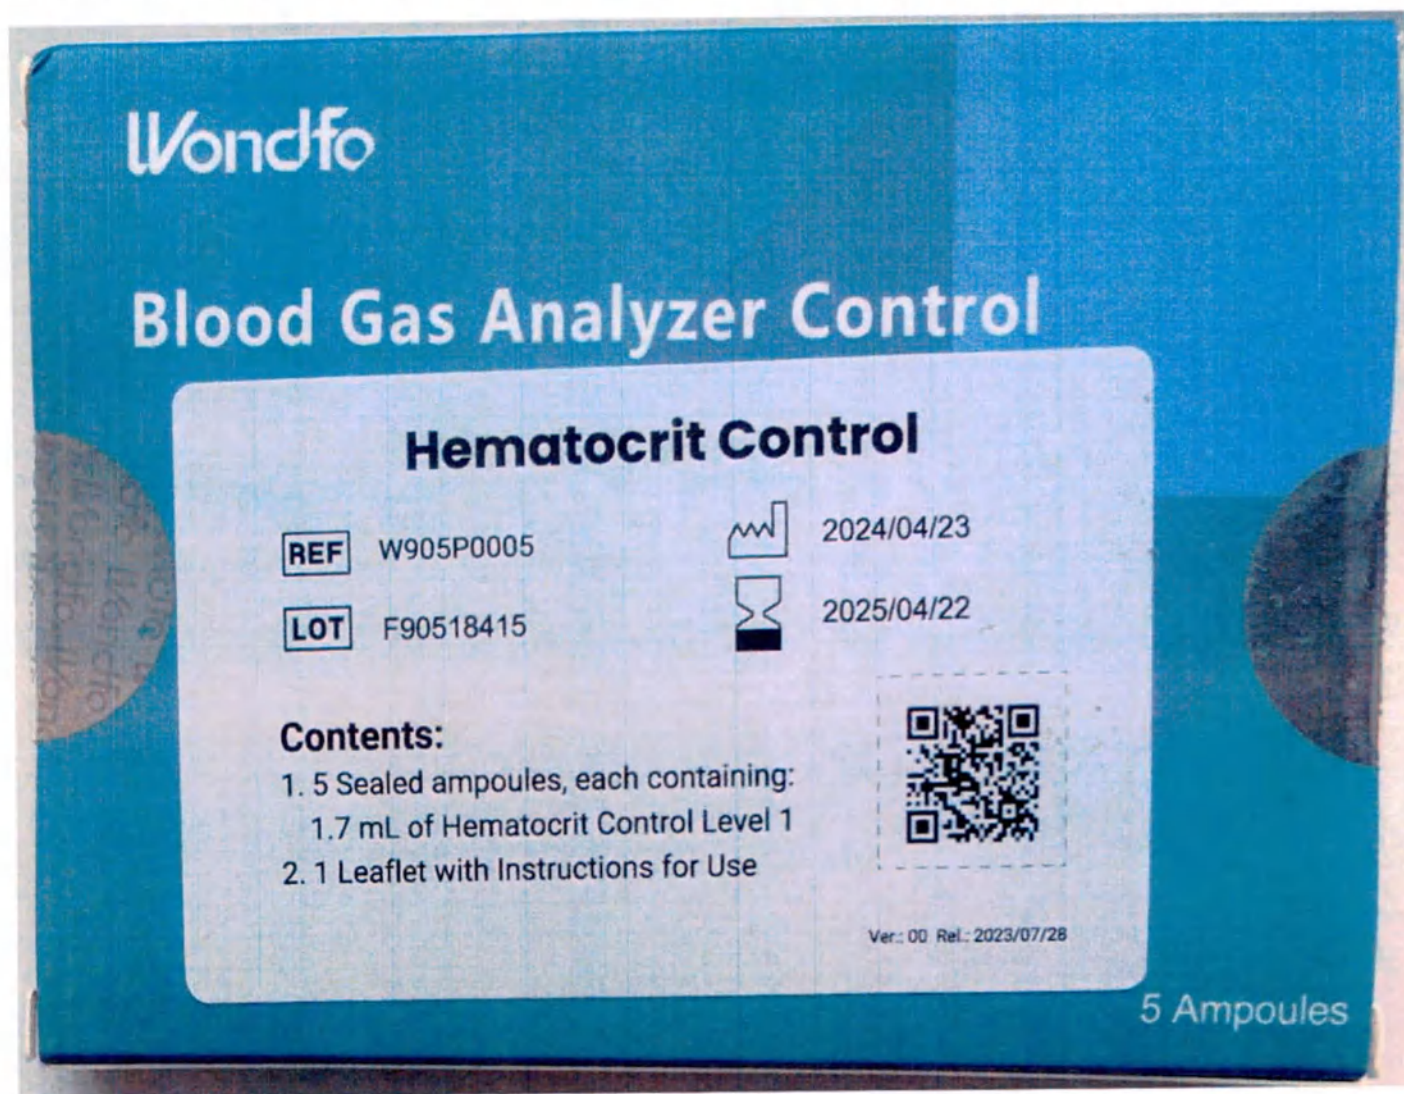

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1




HCT-L1

Wondfo




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R. China
TEL: (+86) 400-830-8768
E-mail: sales@wondfo.com.cn
Website: en.wondfo.com

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1

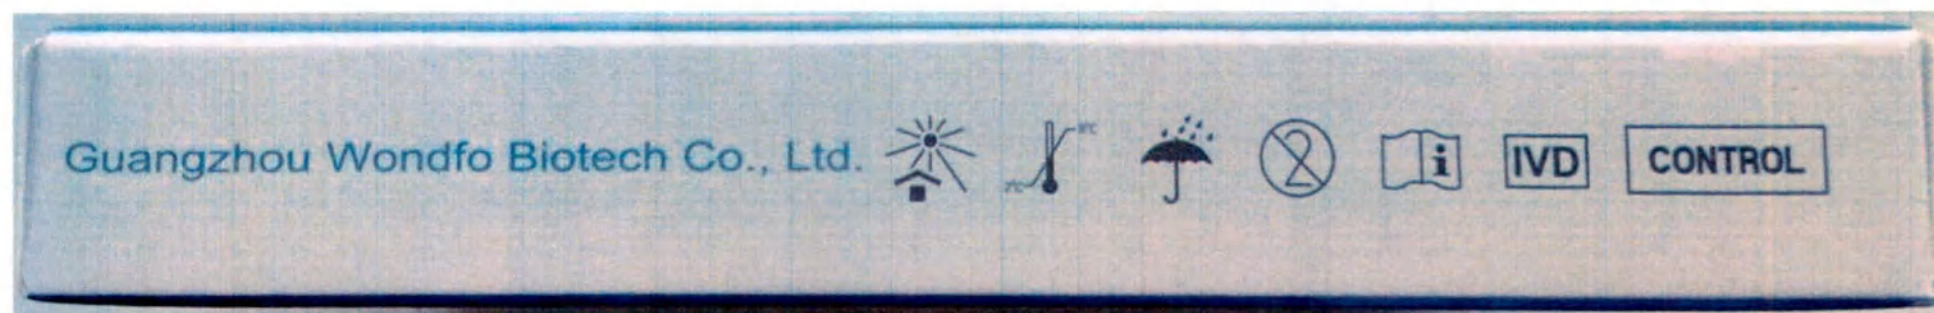

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1

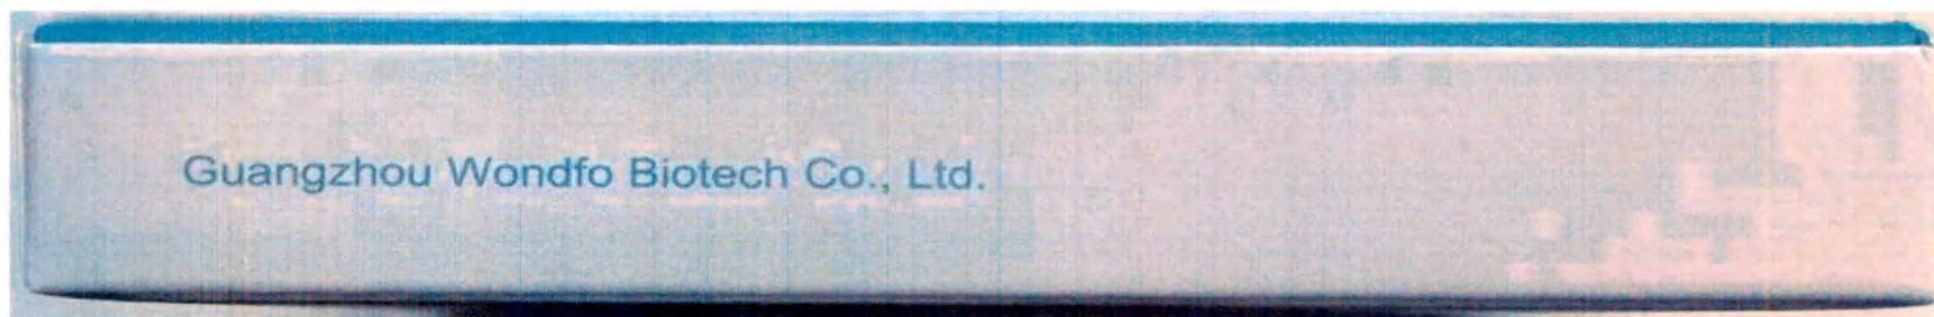

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1




Внешний вид ампул, варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотного-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1



Маркировка, наносимая на флакон варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 1



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики in vitro для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2

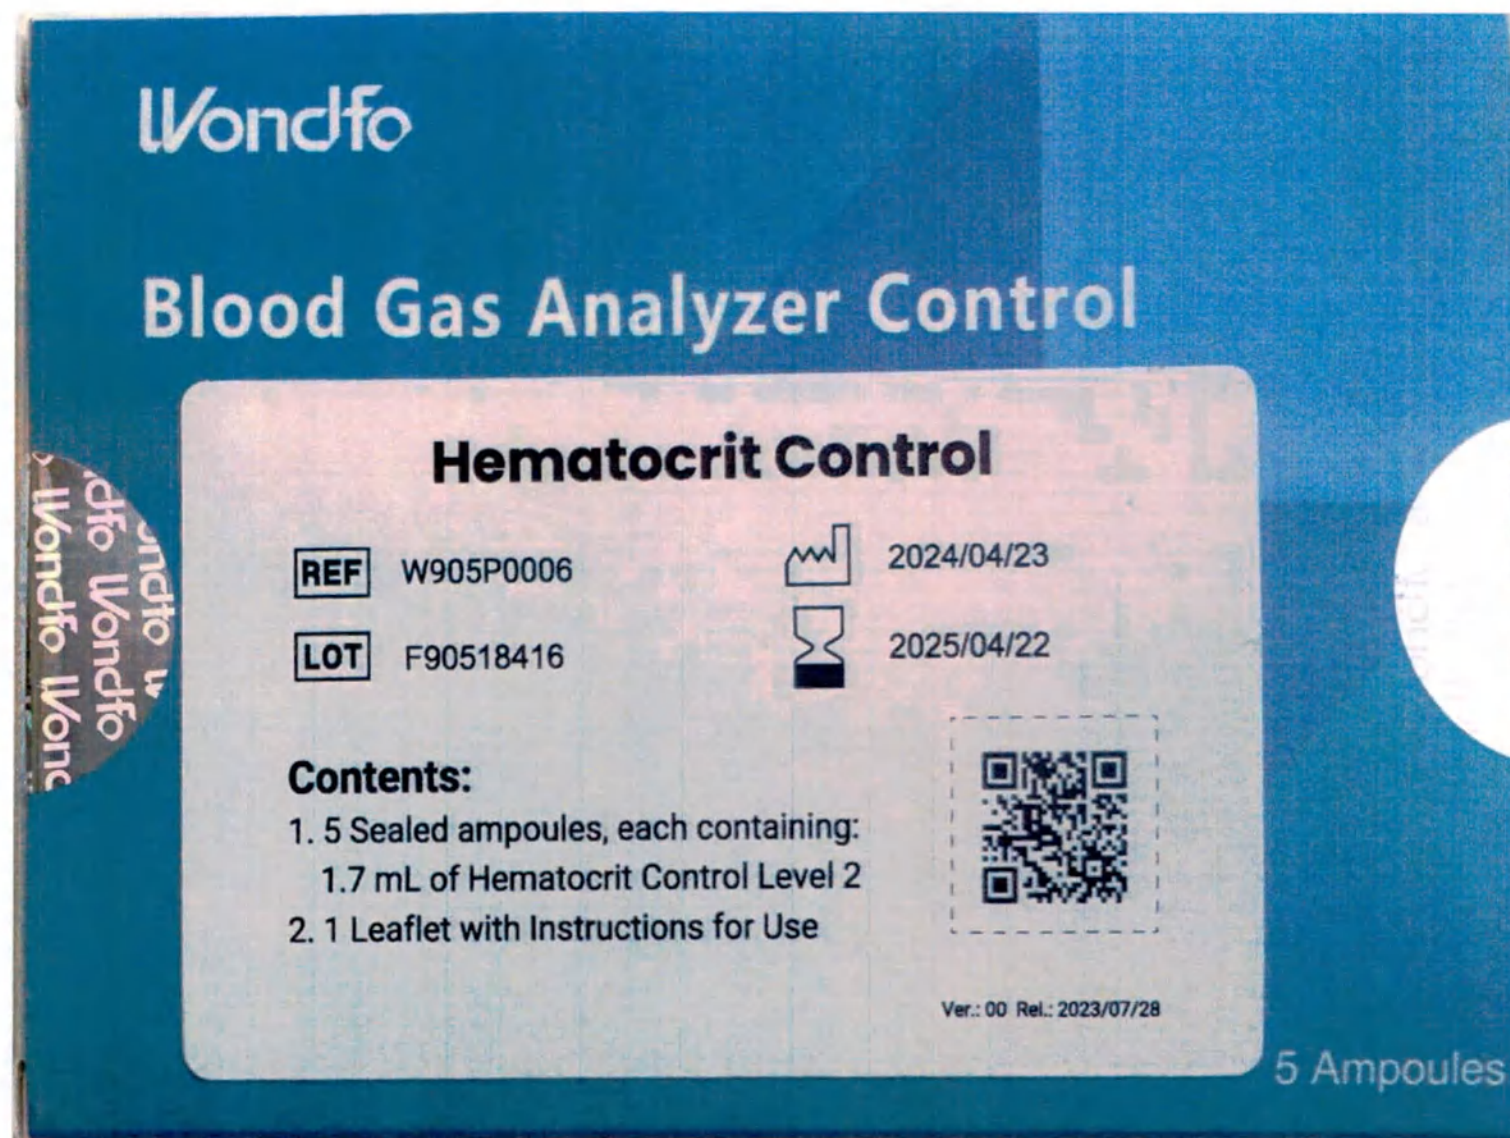

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2




HCT-L2

Wondfo




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R. China
TEL: (+86) 400-830-8768
E-mail: sales@wondfo.com.cn
Website: en.wondfo.com

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2

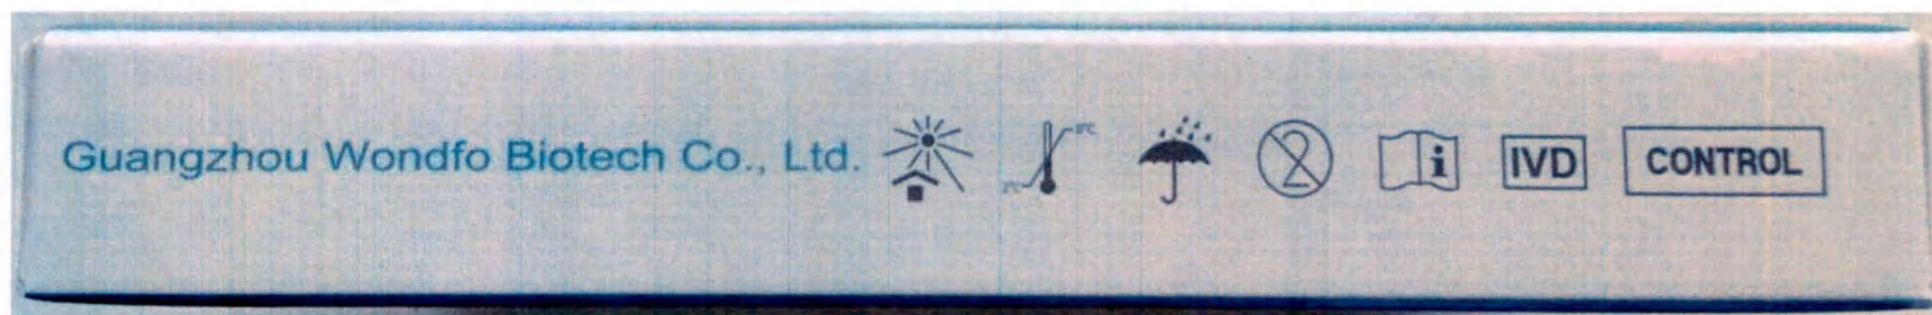

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2

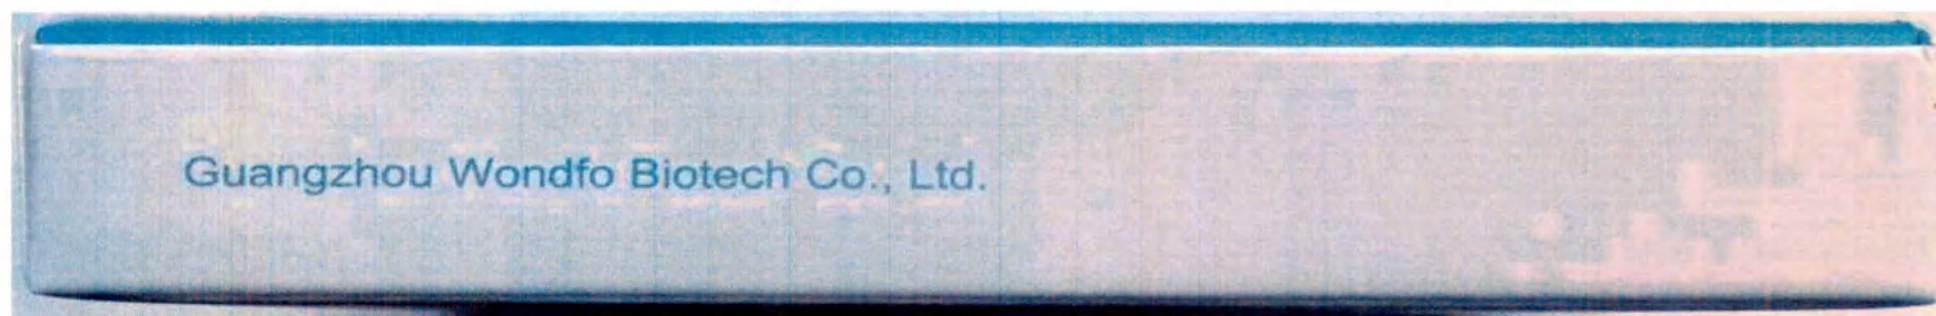

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usage-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3)и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку варианта исполнения Набор контрольных материалов для анализатора кислотно-щелочного и газового состава крови Usare-6000 для диагностики *in vitro* для контроля параметров уровня pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac (уровень 1/уровень 2/уровень 3) и Hct (уровень 1/уровень 2) – Hct Уровень 2



**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

69 (шестьдесят девять) листов
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись В.В. Родикова

« _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

