

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

В.Г. Акимкин

«22» октября 2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV),
ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита
человека (HIV) методом ПЦР
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

[illegible]

Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1. После вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)

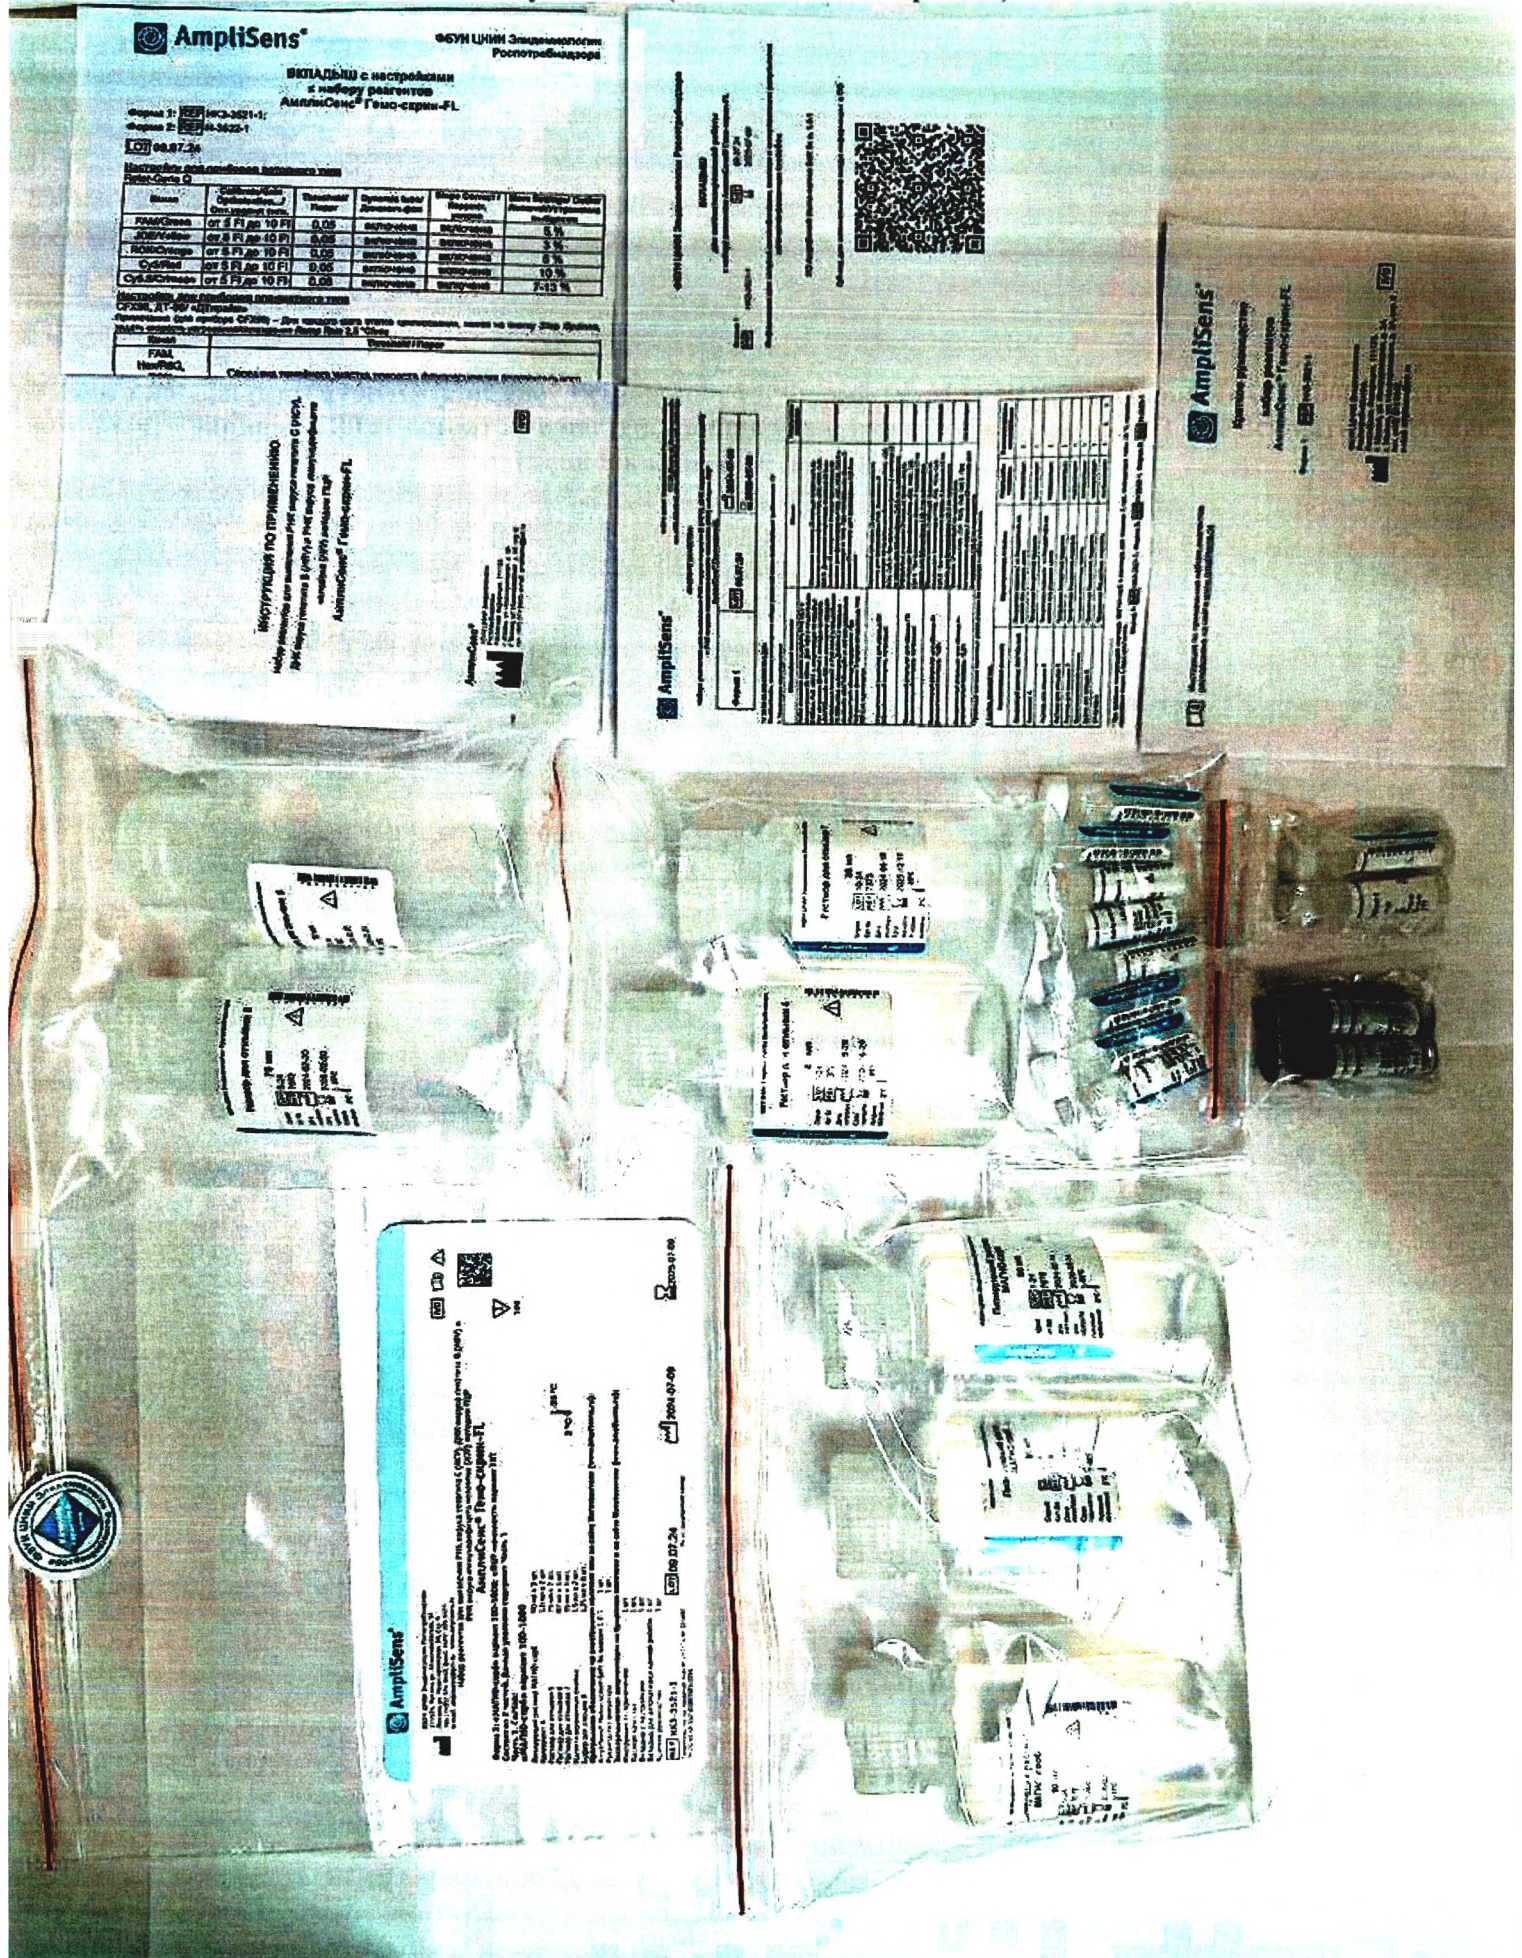


Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2. После вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock)



Amplicon

АмплиСенс® Реагенты для ПЦР

ООО «Цирми» (ИНН 50/0011000000, ОГРН 1045000000000)
125080, Москва, ул. Зарядье, д. 10, стр. 1, этаж 1
тел. (495) 321-11-11, факс (495) 321-11-12, e-mail: info@cirmi.ru

Набор реагентов для исследования РНК вируса гепатита С (HCV), для выявления патогена и (или) для выявления антител к HCV

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000;

«ПЦР-комплект» вариант FRT

Часть 2: 2 части, для выявления патогена и (или) для выявления антител к HCV

«ПЦР-комплект» вариант FRT

В комплект входит:

01. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

02. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

03. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

04. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

05. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

06. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

07. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

08. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

09. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

10. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

11. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

12. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

13. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

14. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

15. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

16. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

17. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

18. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

19. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

20. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

21. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

22. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

23. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

24. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

25. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

26. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

27. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

28. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

29. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

30. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

31. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

32. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

33. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

34. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

35. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

36. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

37. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

38. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

39. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

40. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

41. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

42. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

43. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

44. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

45. ПЦР-комплект: 1 шт. / 100 / 1000 / 1000

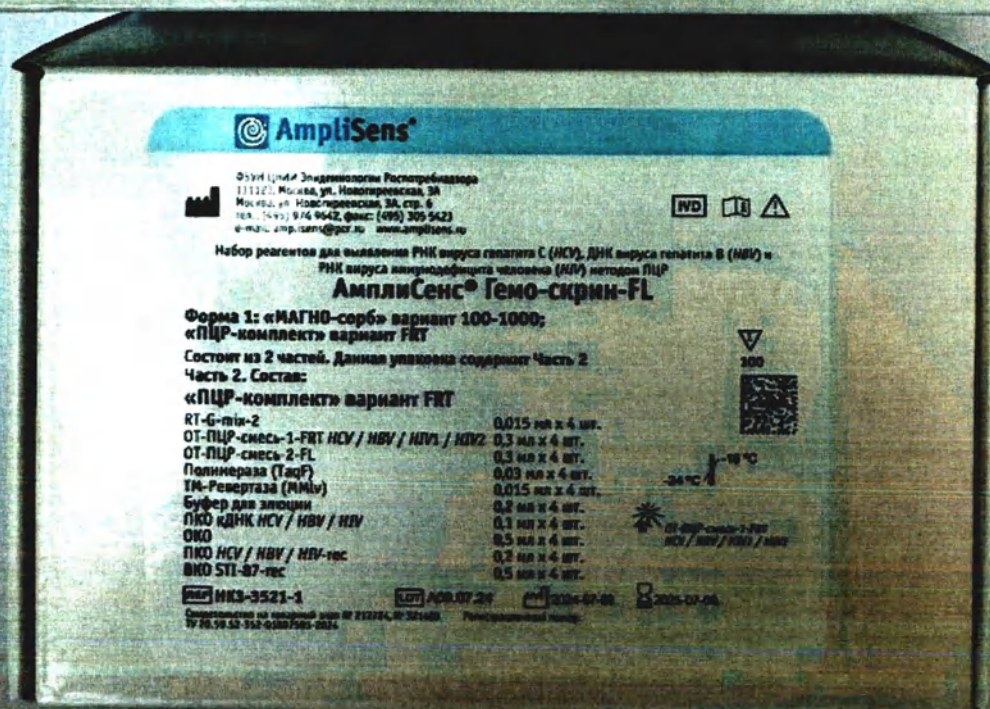
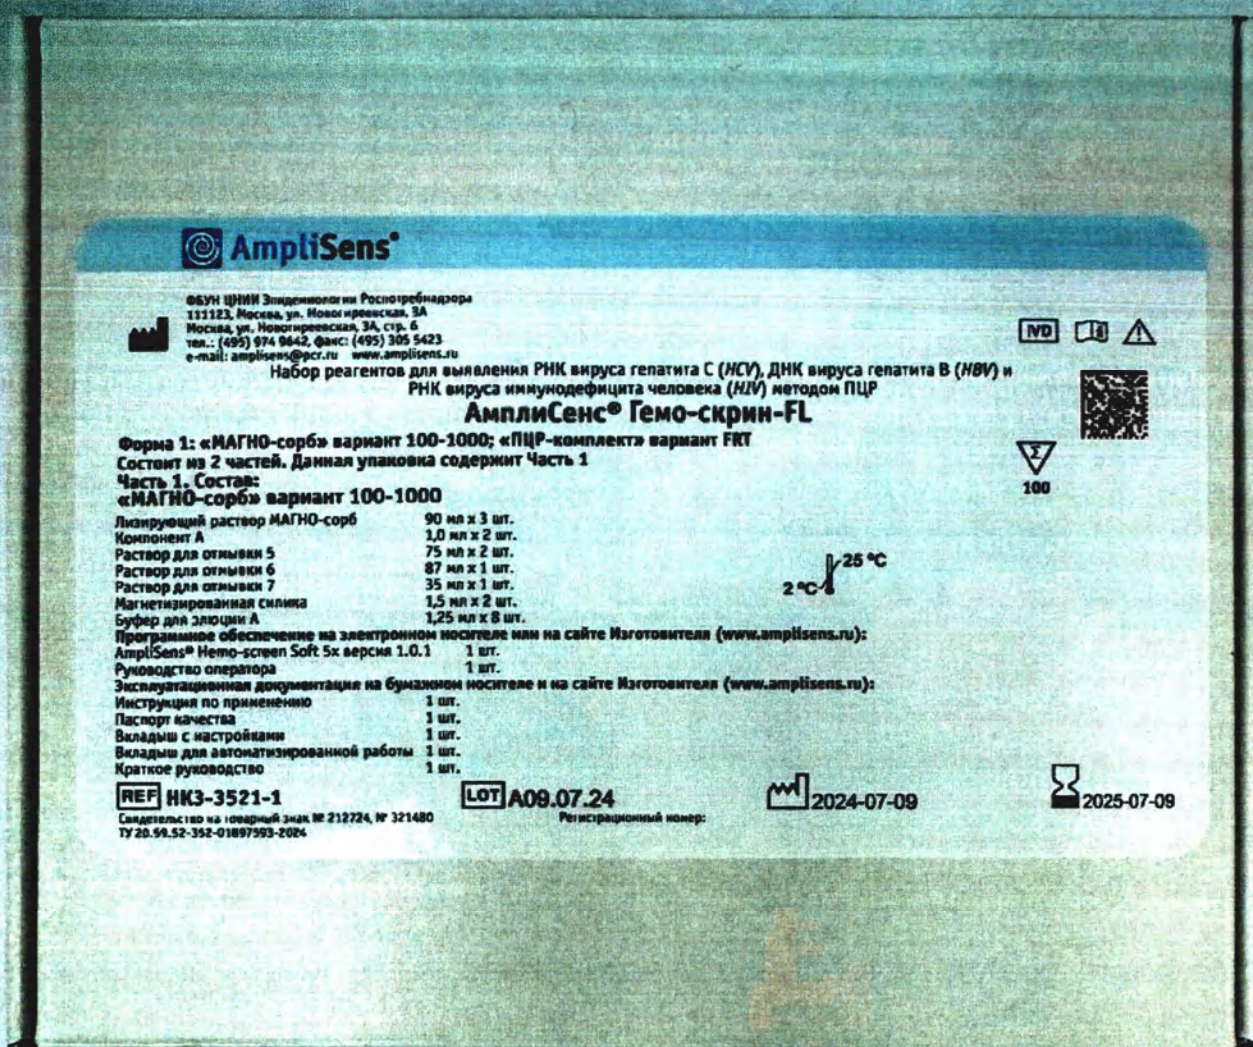


Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1. После вскрытия внешней упаковки (коробка)

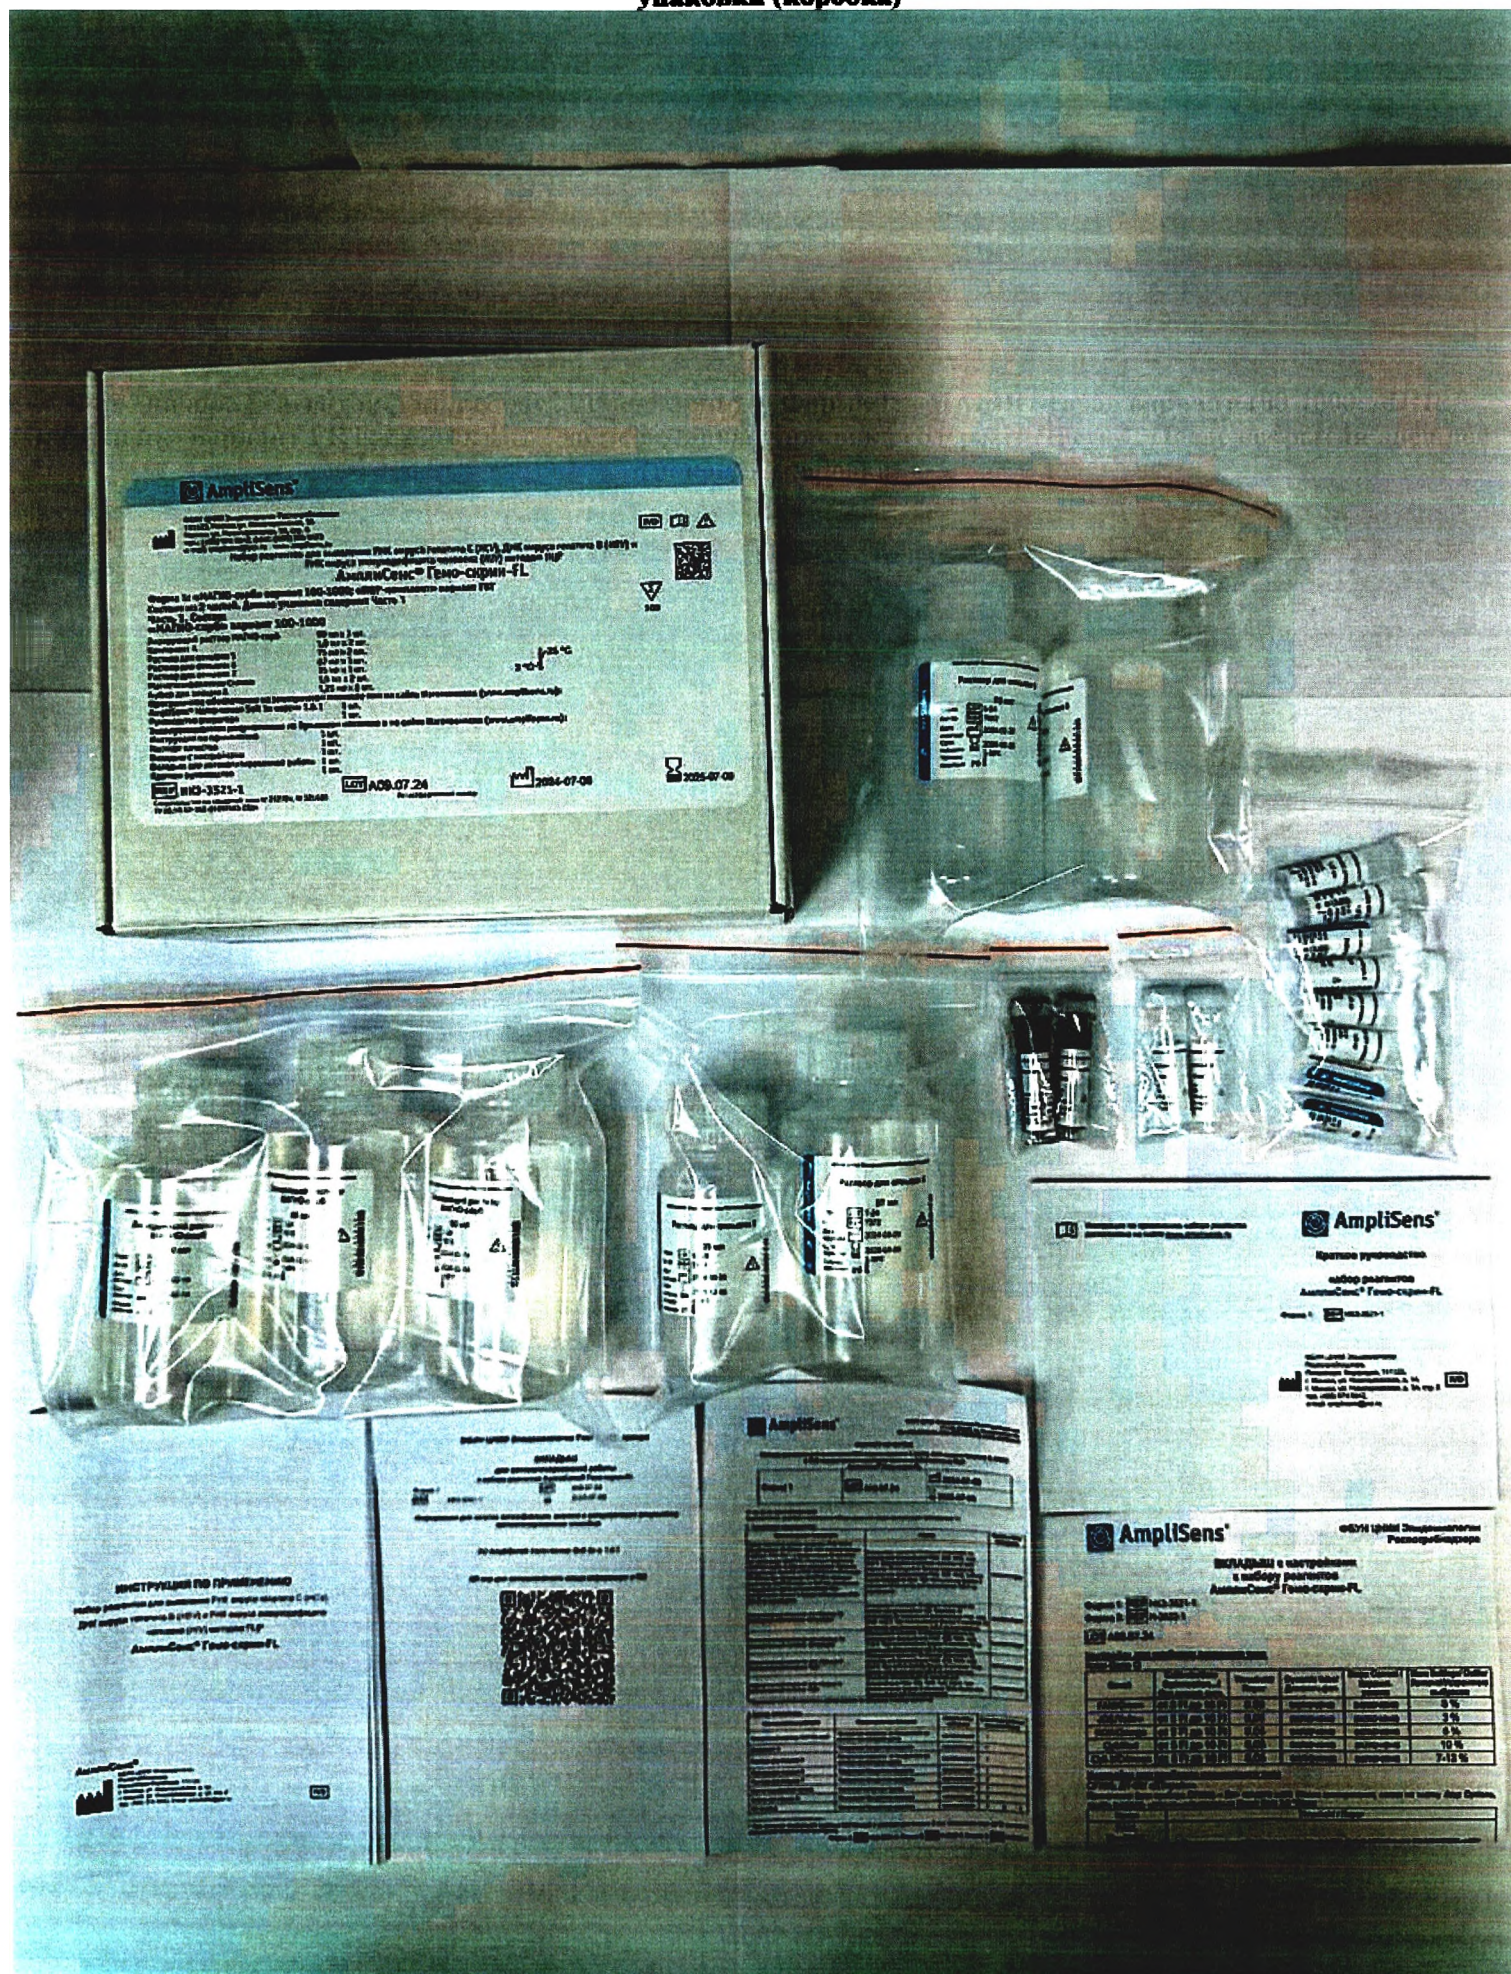


Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2. После вскрытия внешней упаковки (коробка)



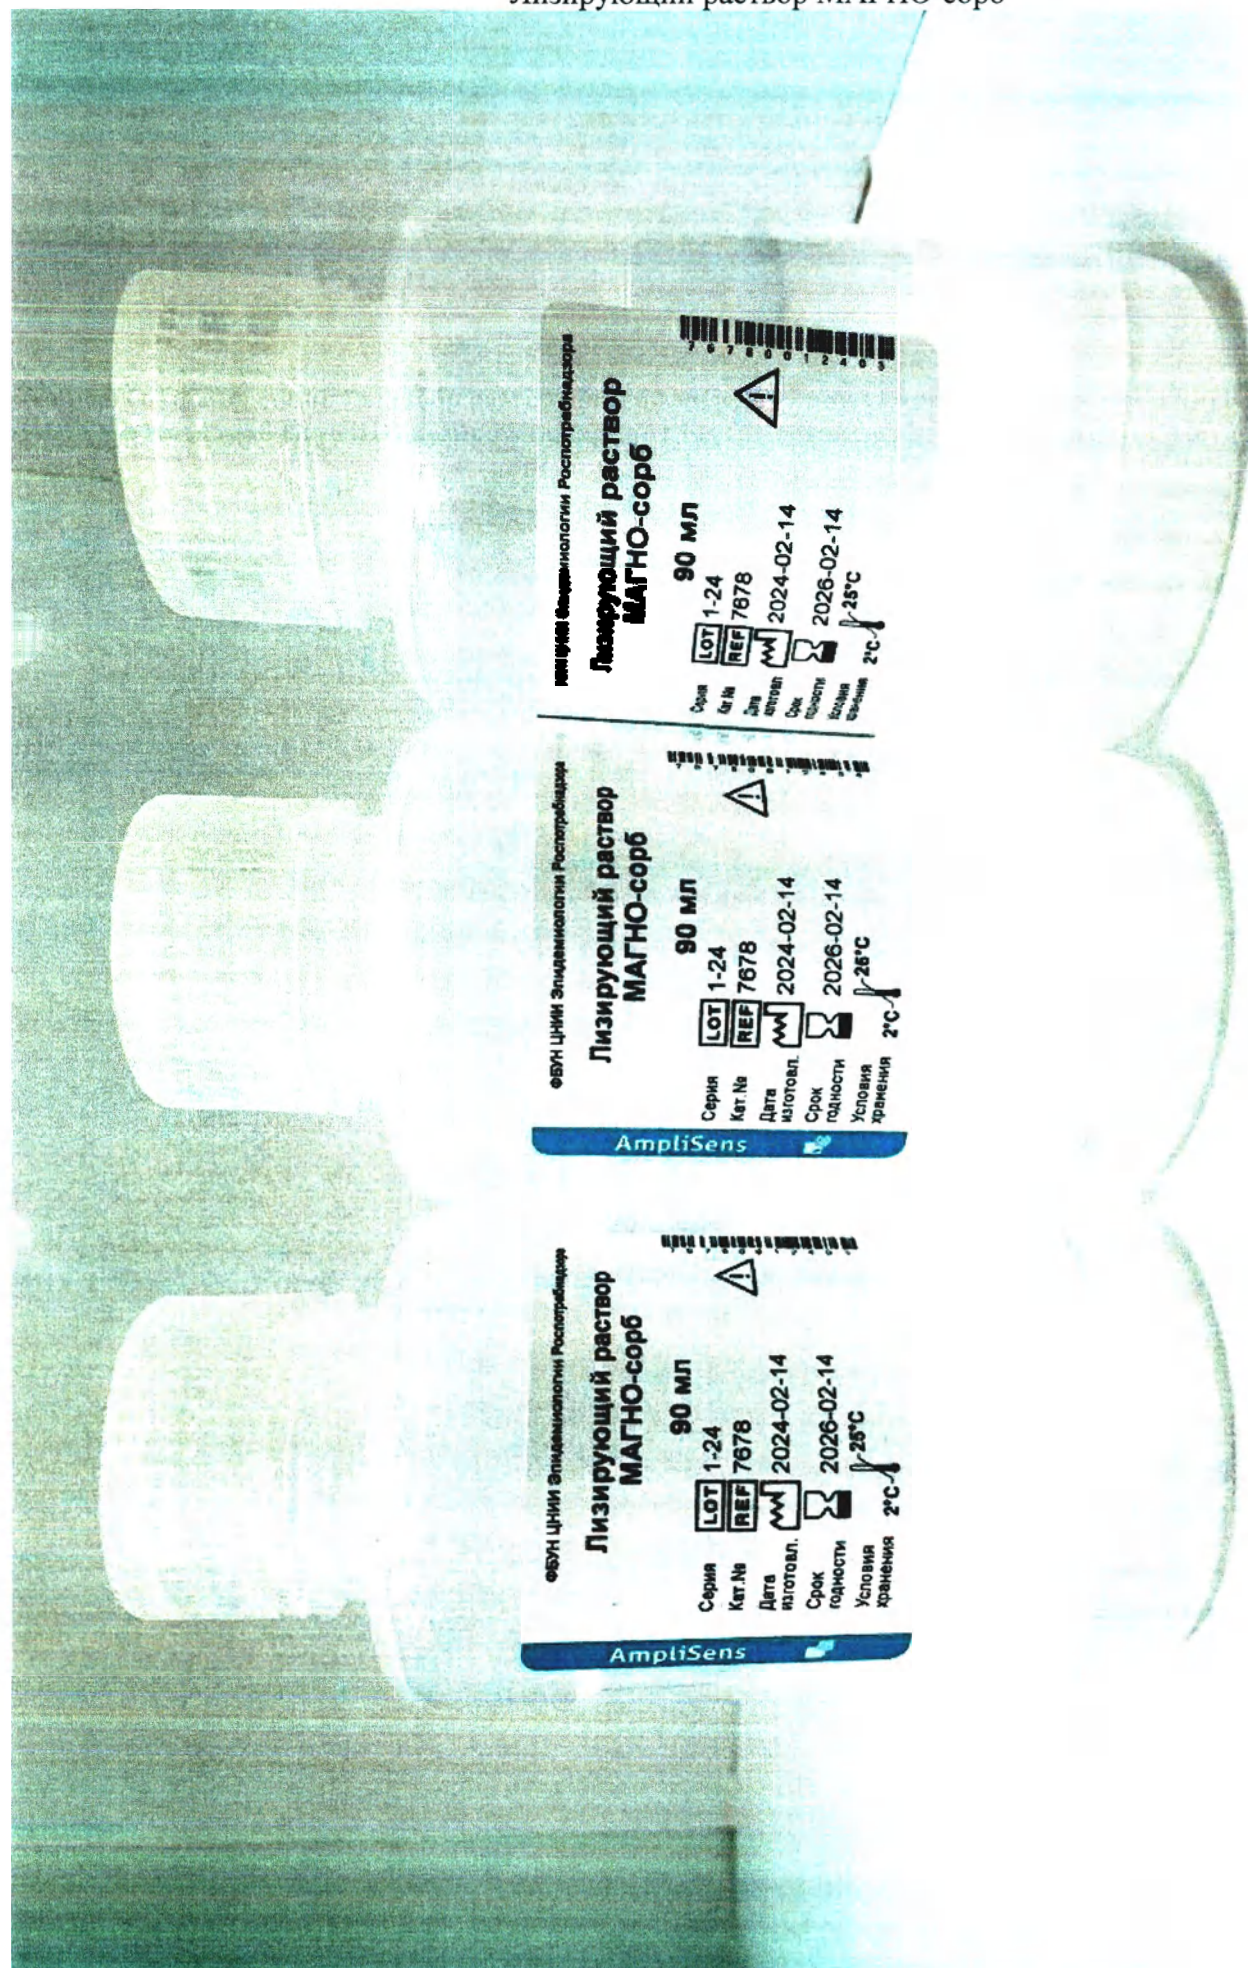
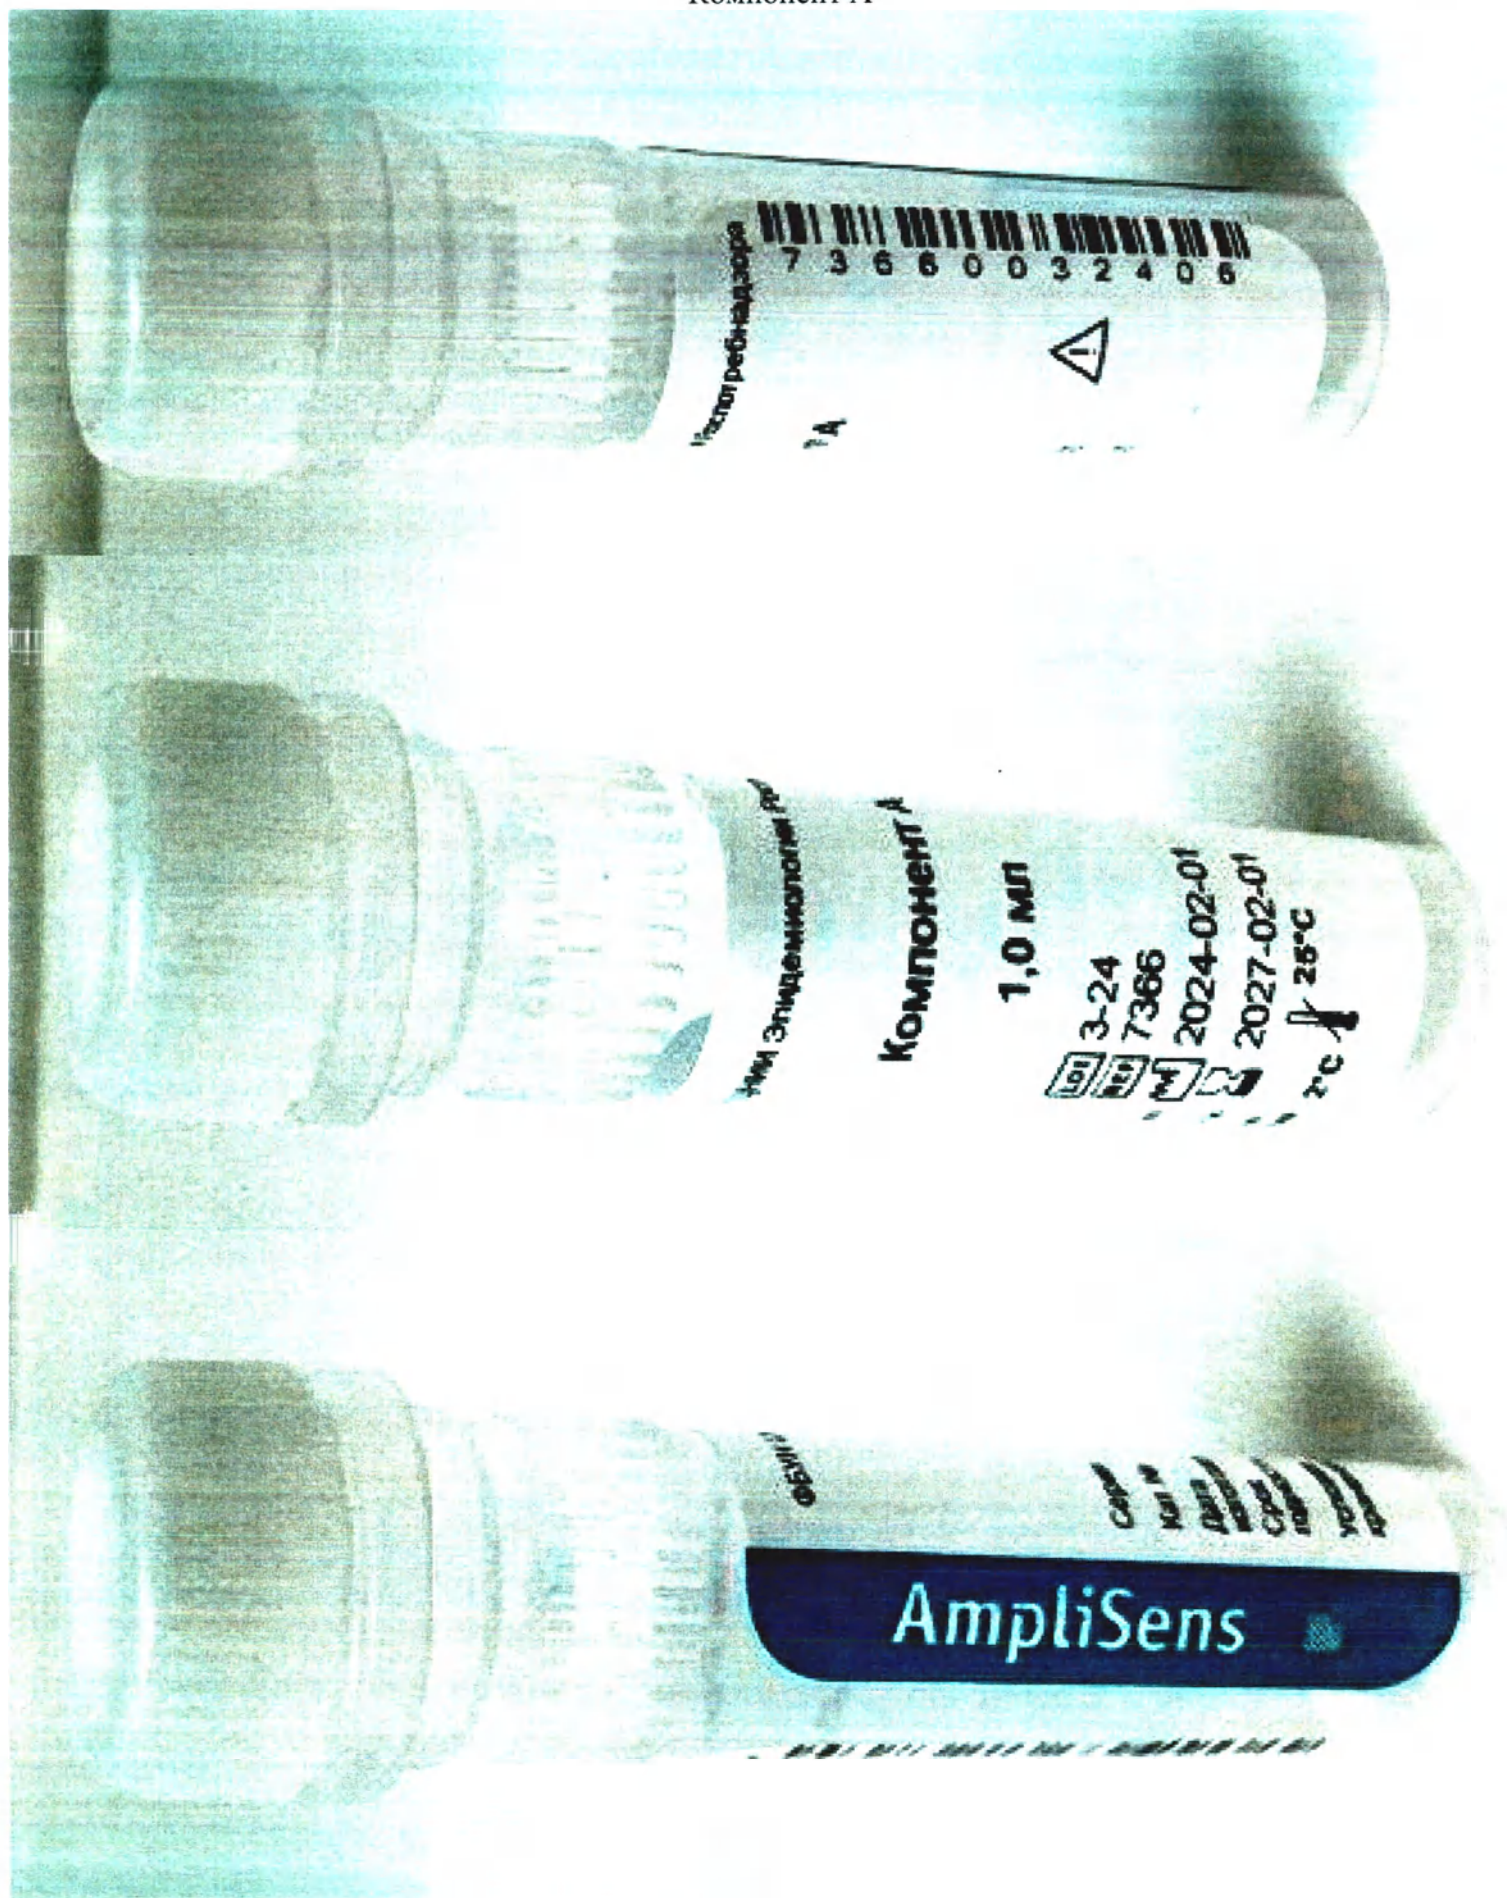


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 1.
Компонент А





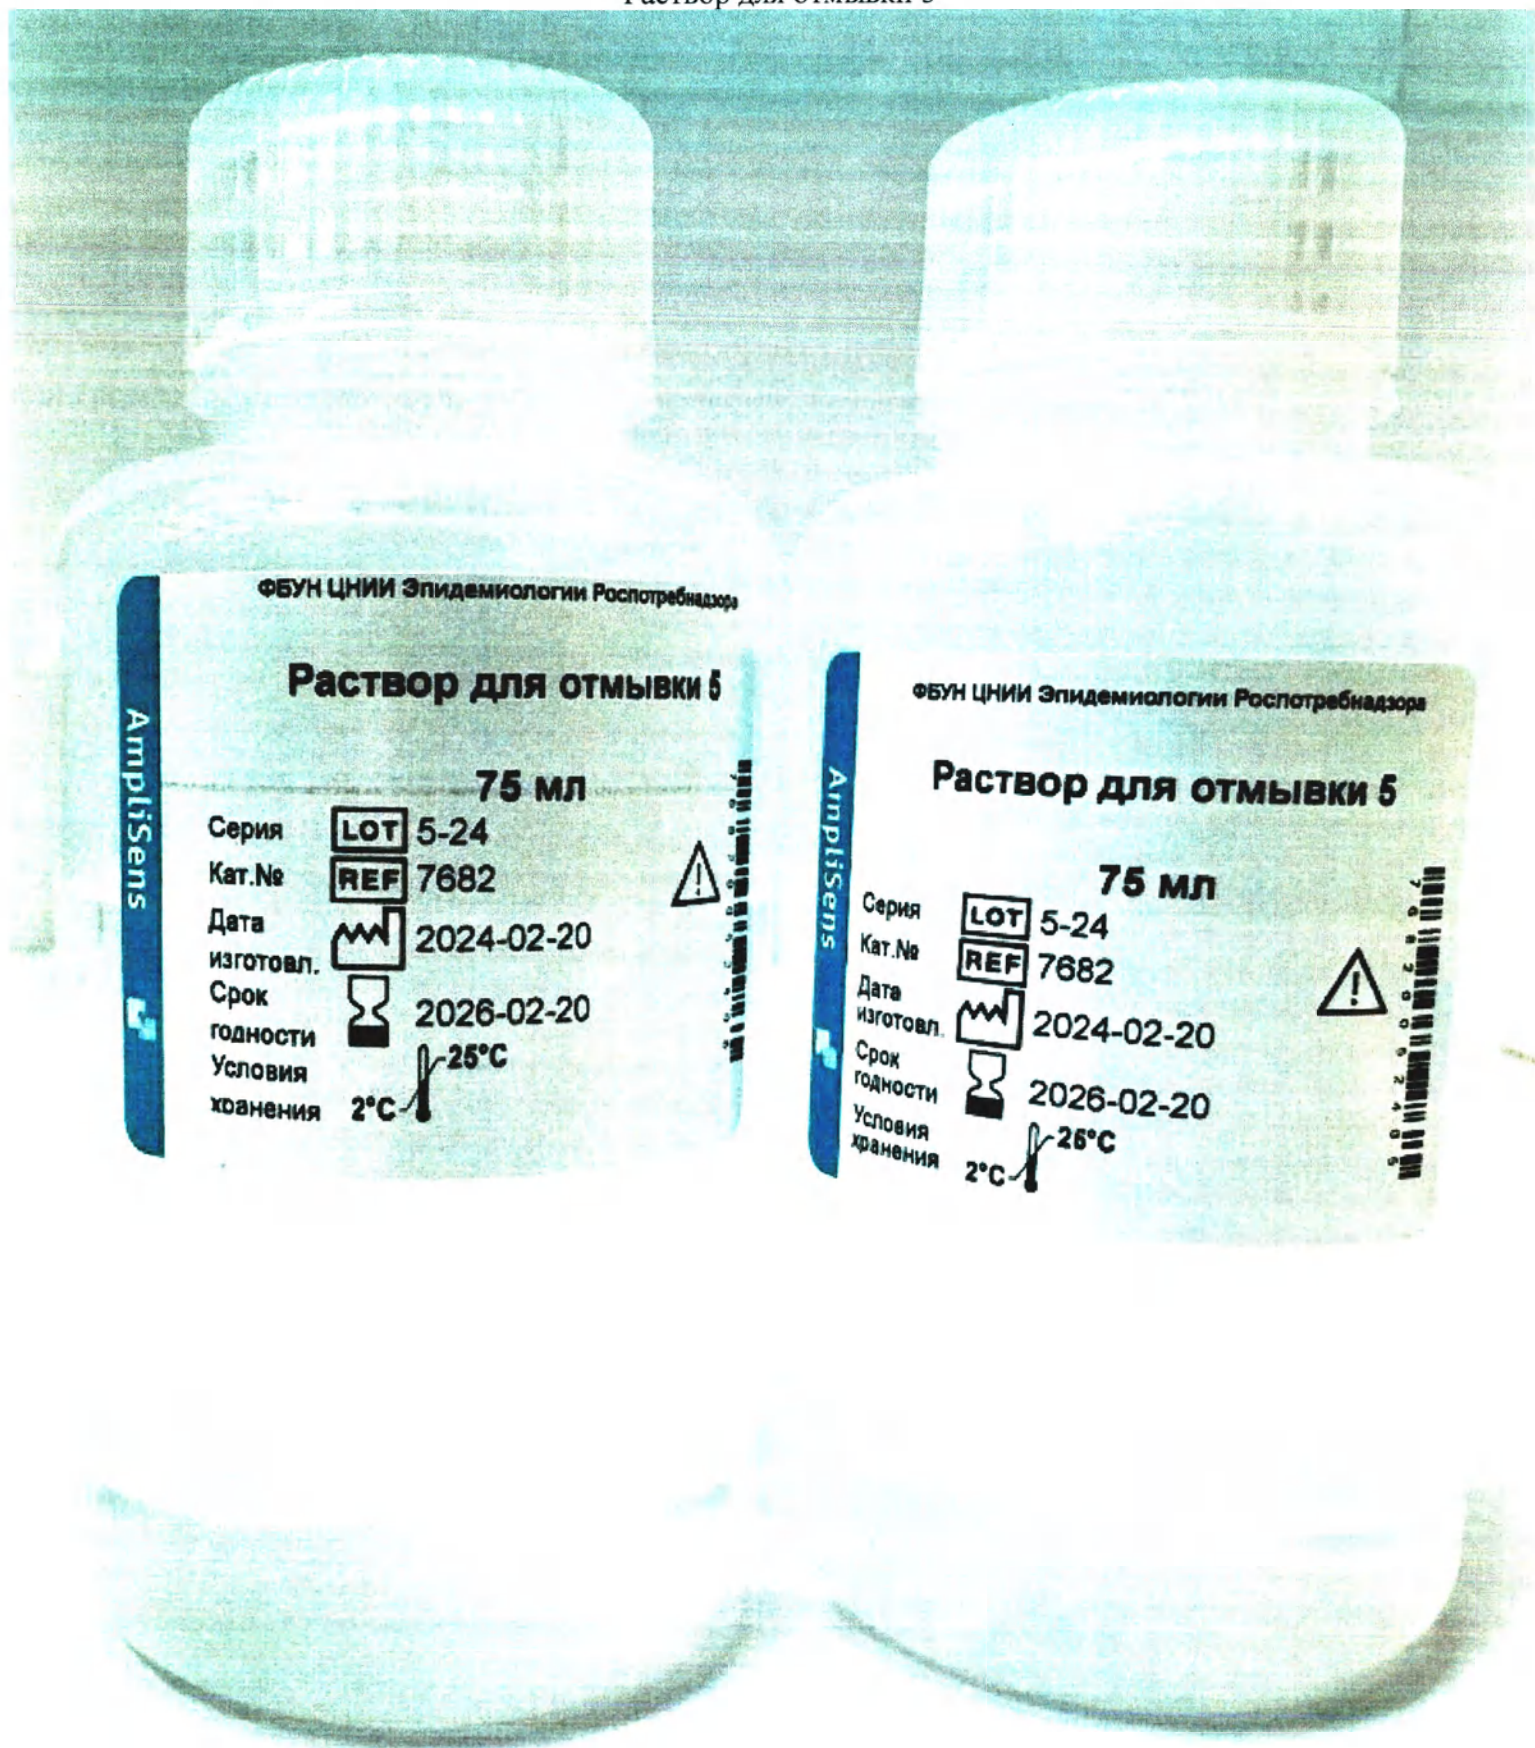


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 1.
Раствор для отмывки 6, Раствор для отмывки 7

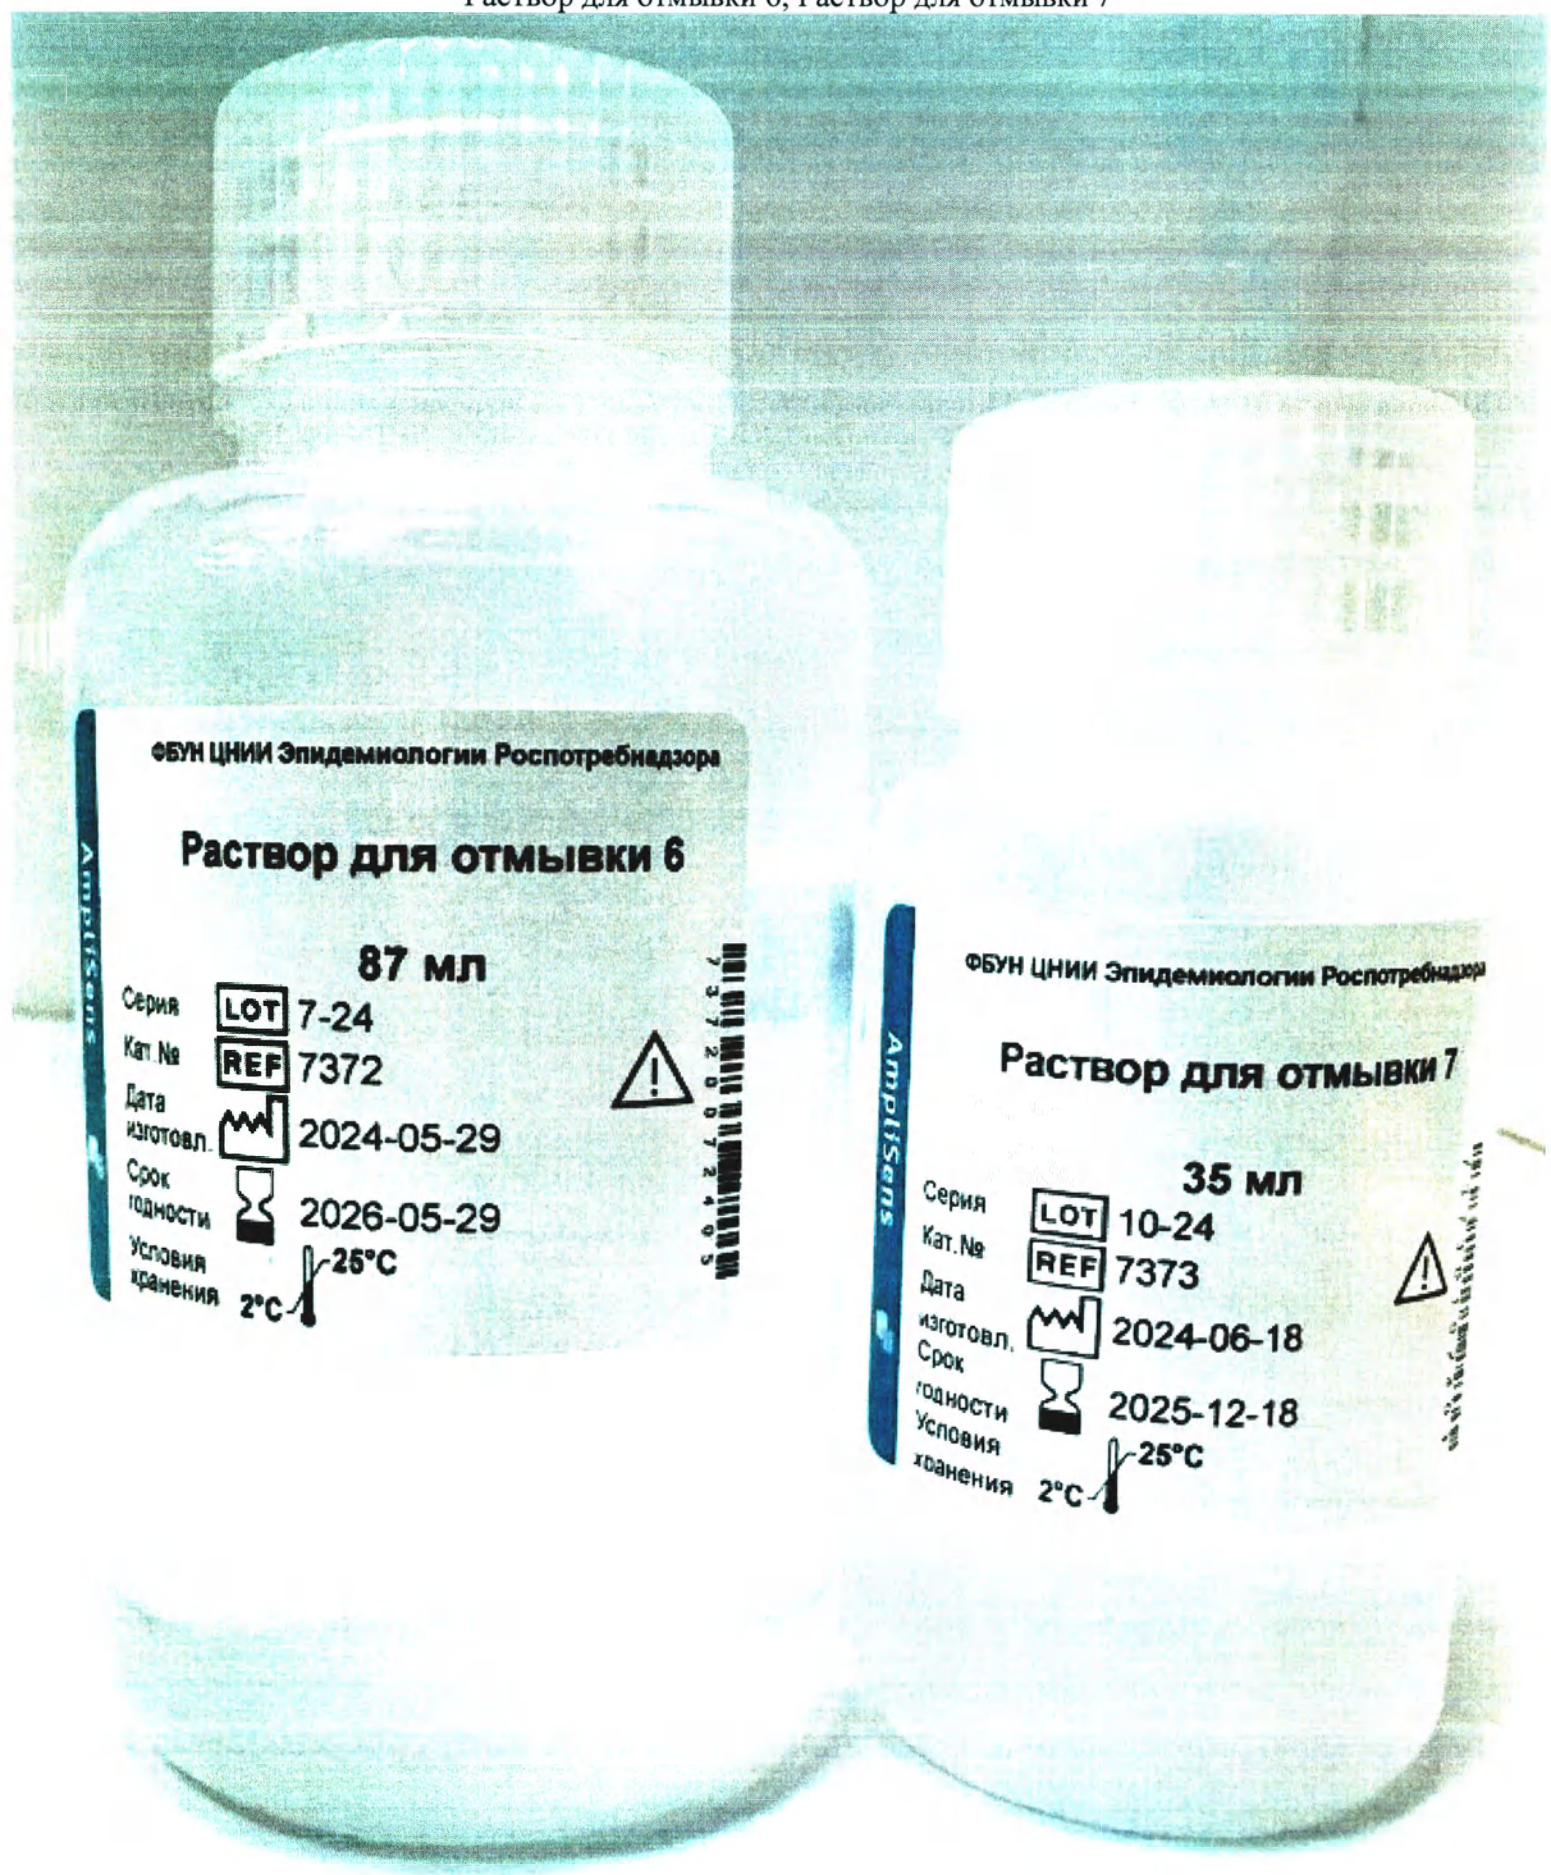


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 1.
Магнетизированная силика



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 1.
Магнетизированная силика



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 1.
Буфер для элюции А

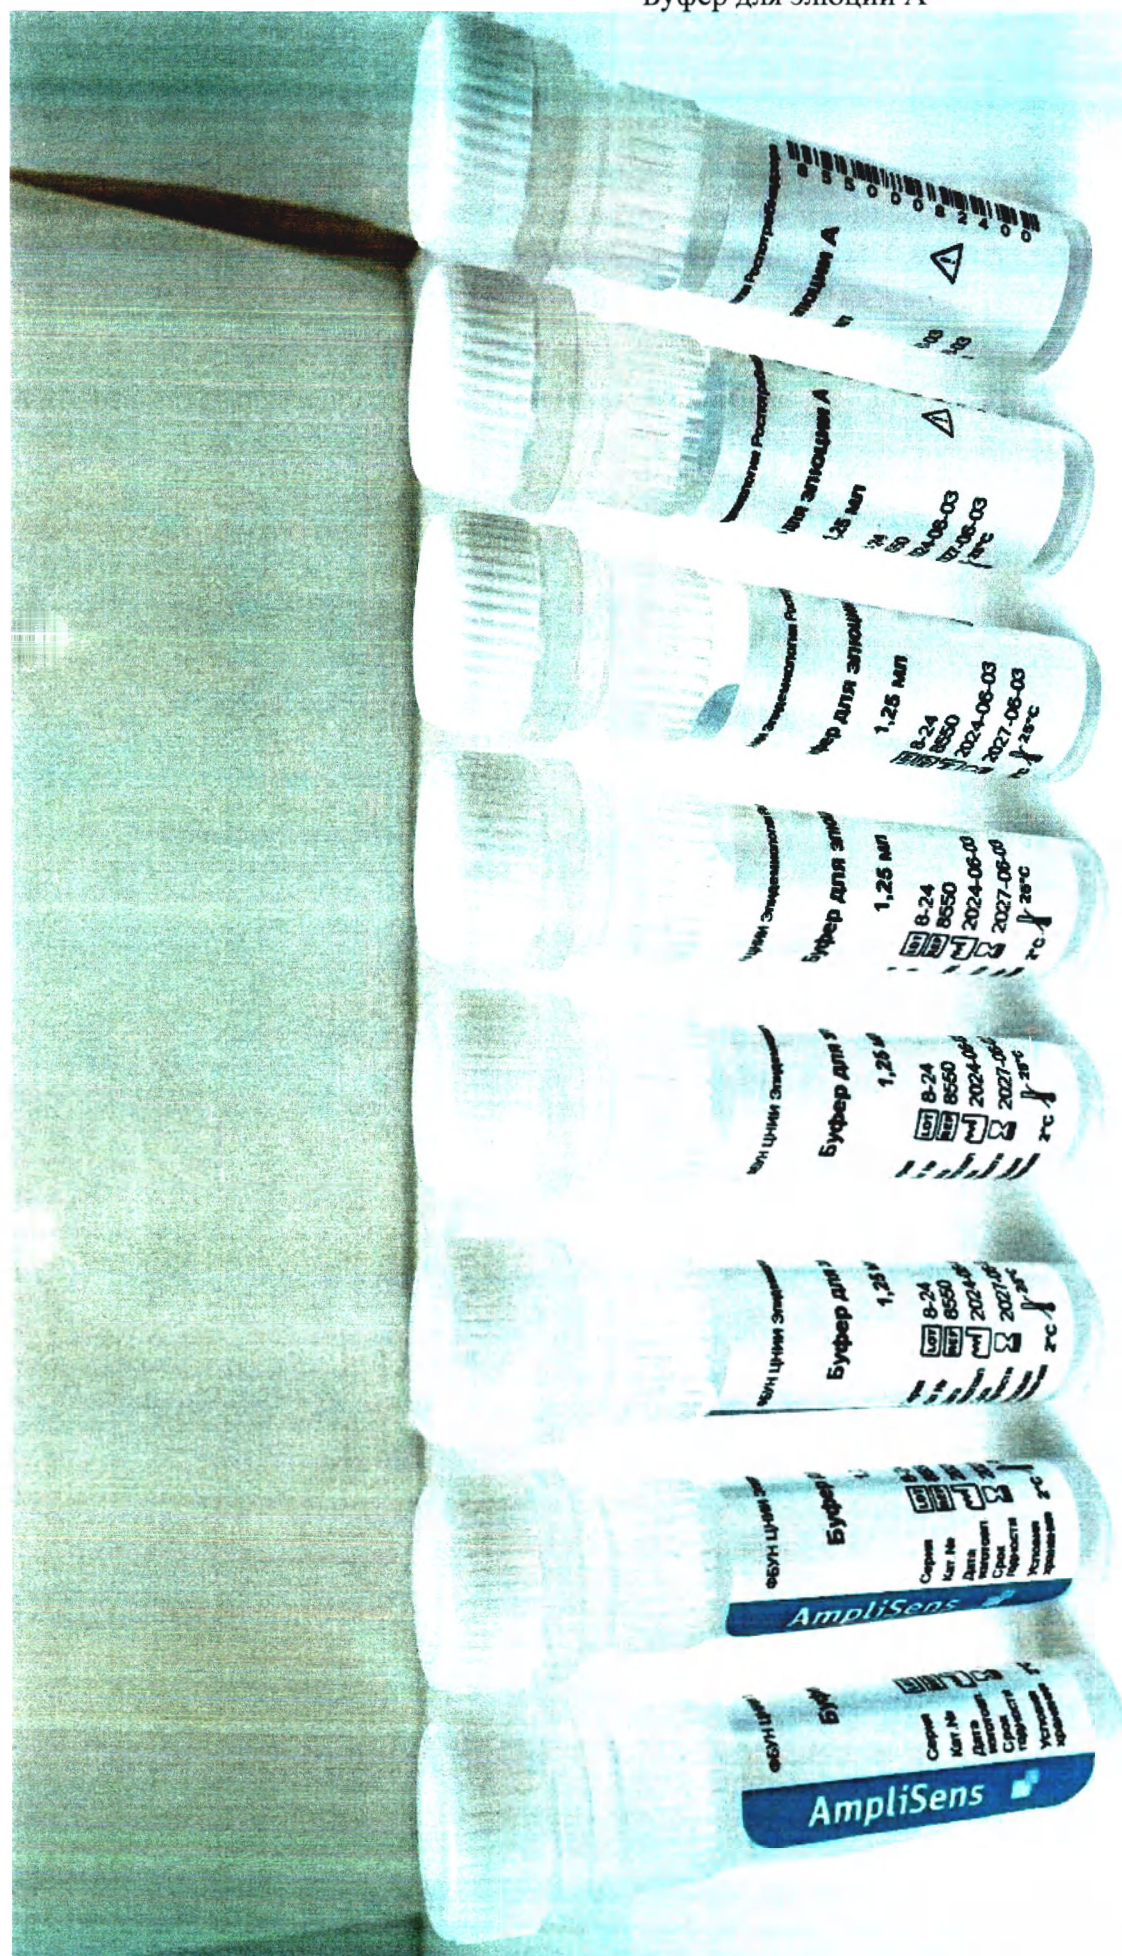


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
ОКО, ПКО HCV / HBV / HIV-rec, ВКО STI-87-rec





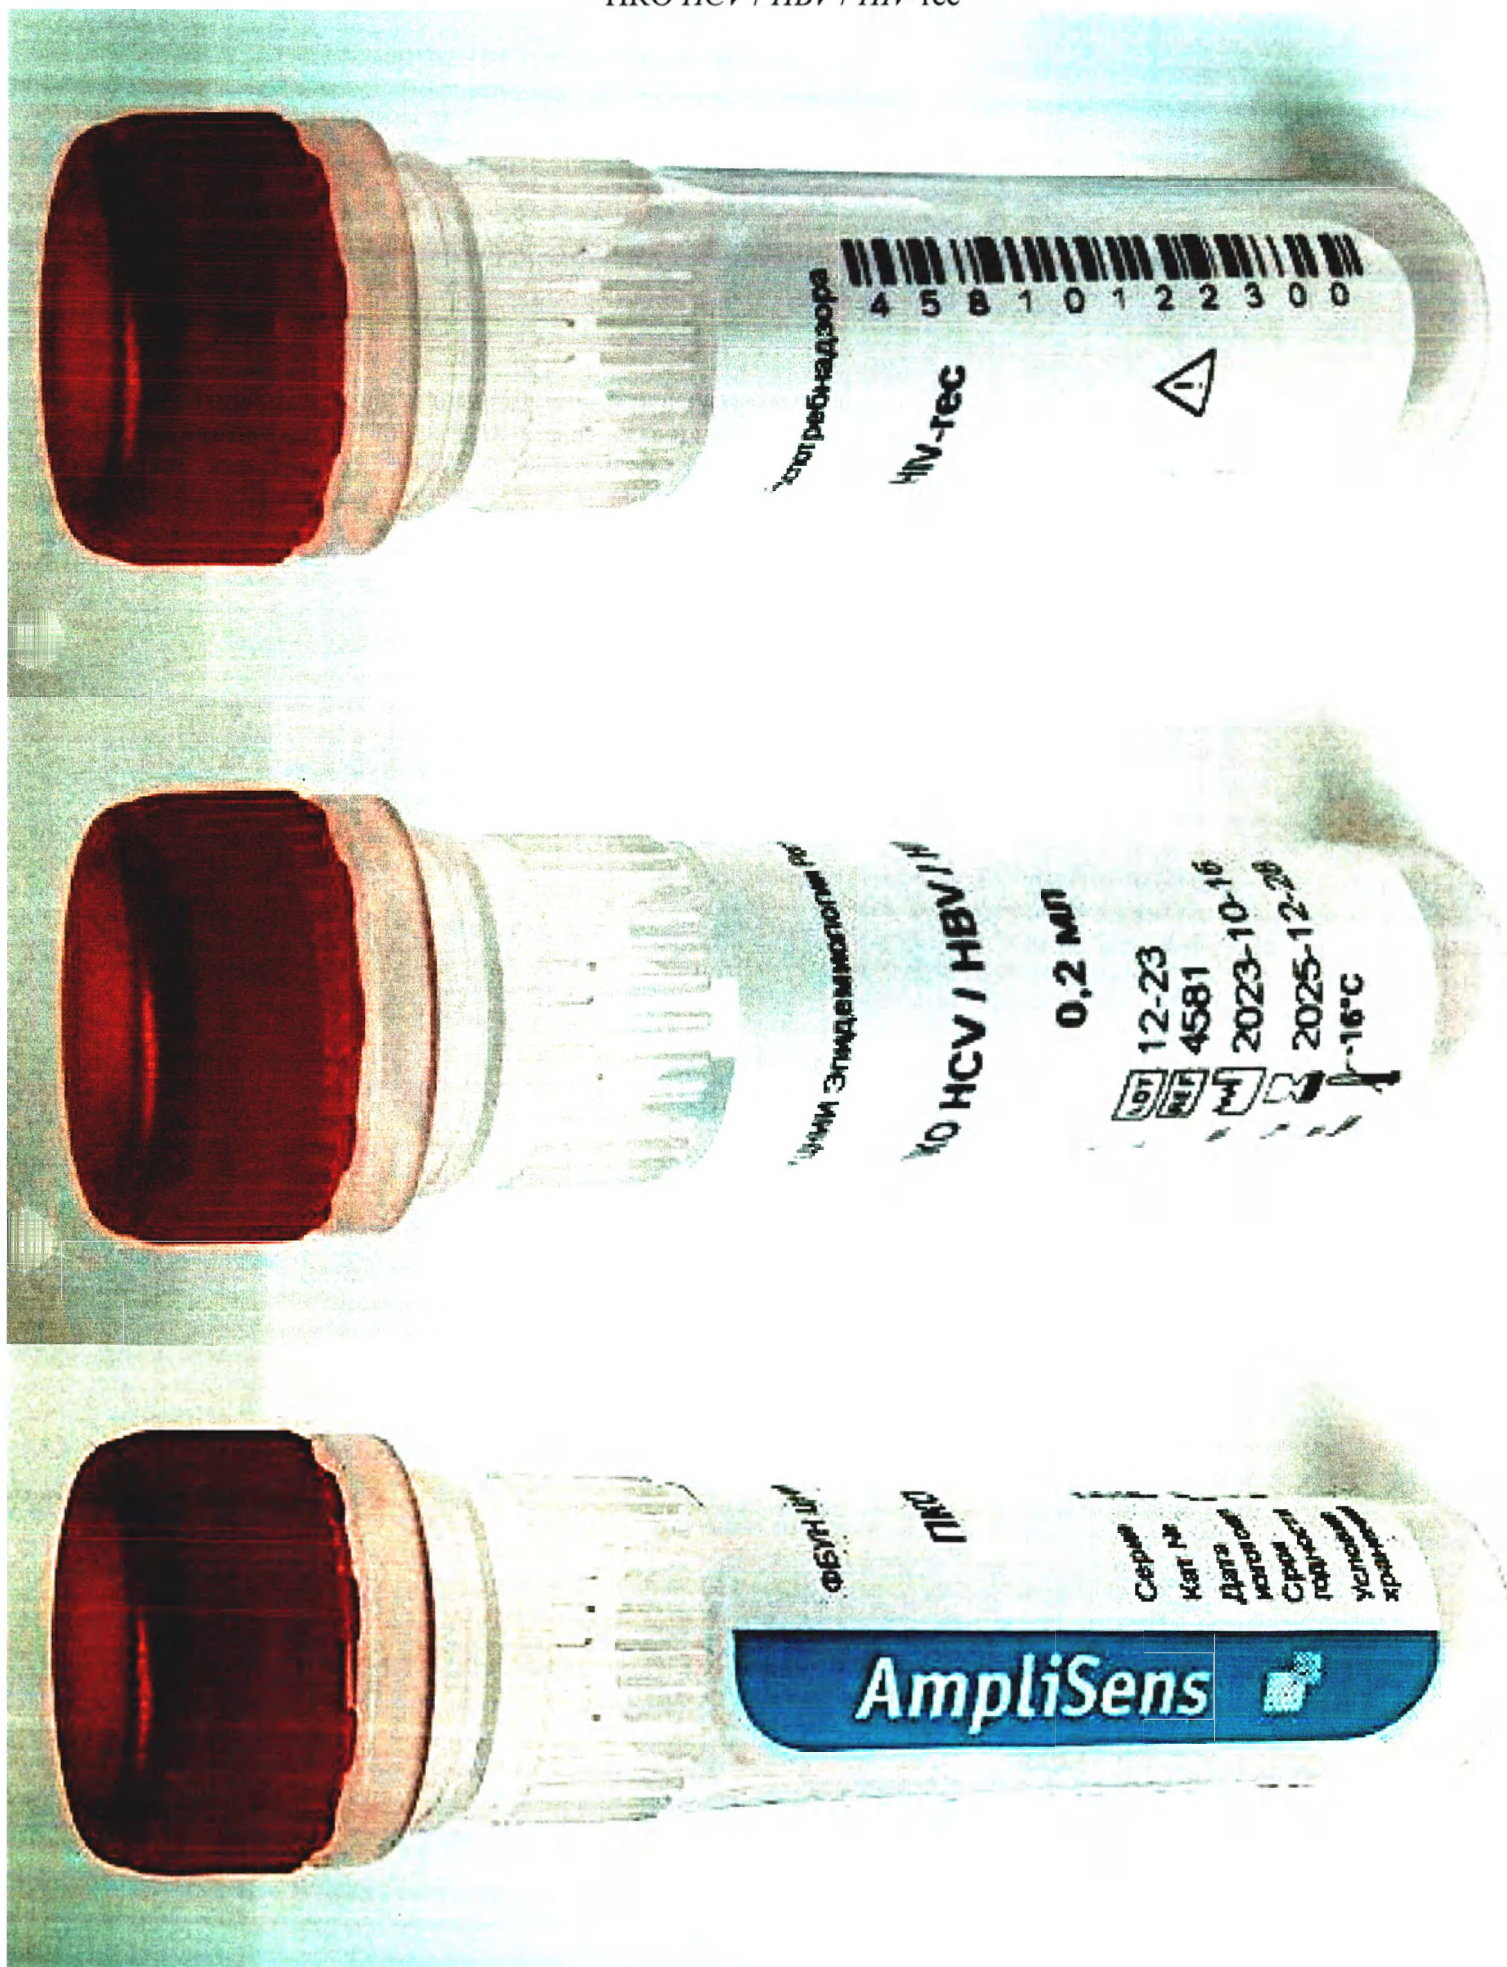
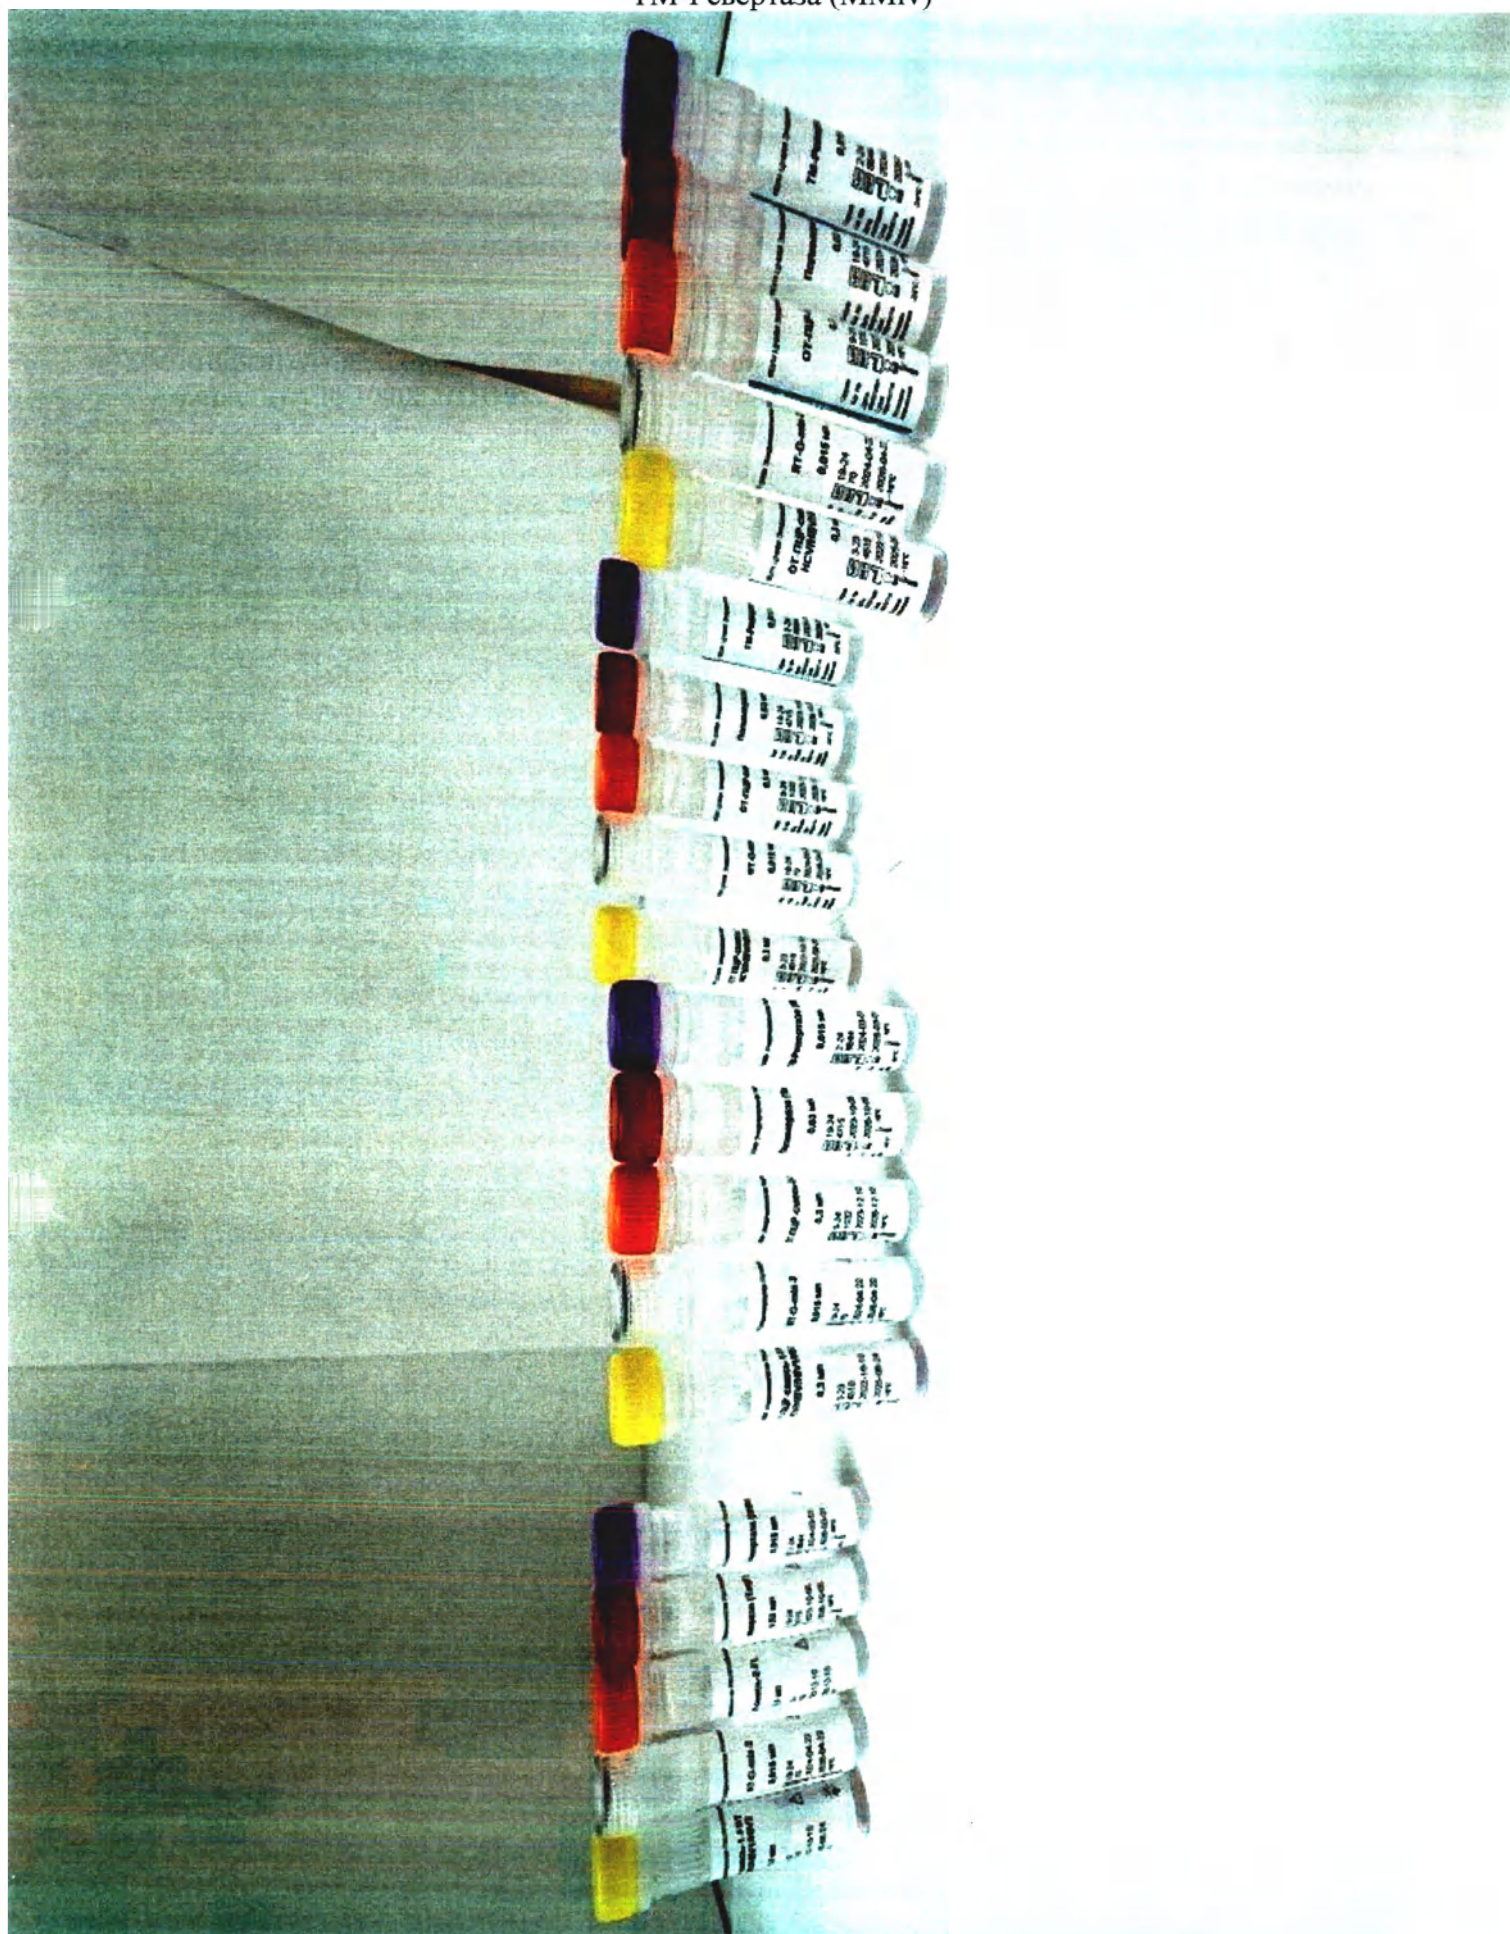


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
ВКО STI-87-гес



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2. RT-G-mix-2, ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2, ОТ-ПЦР-смесь-2-FL, Полимераза (TaqF), ТМ-Ревертаза (MMLv)



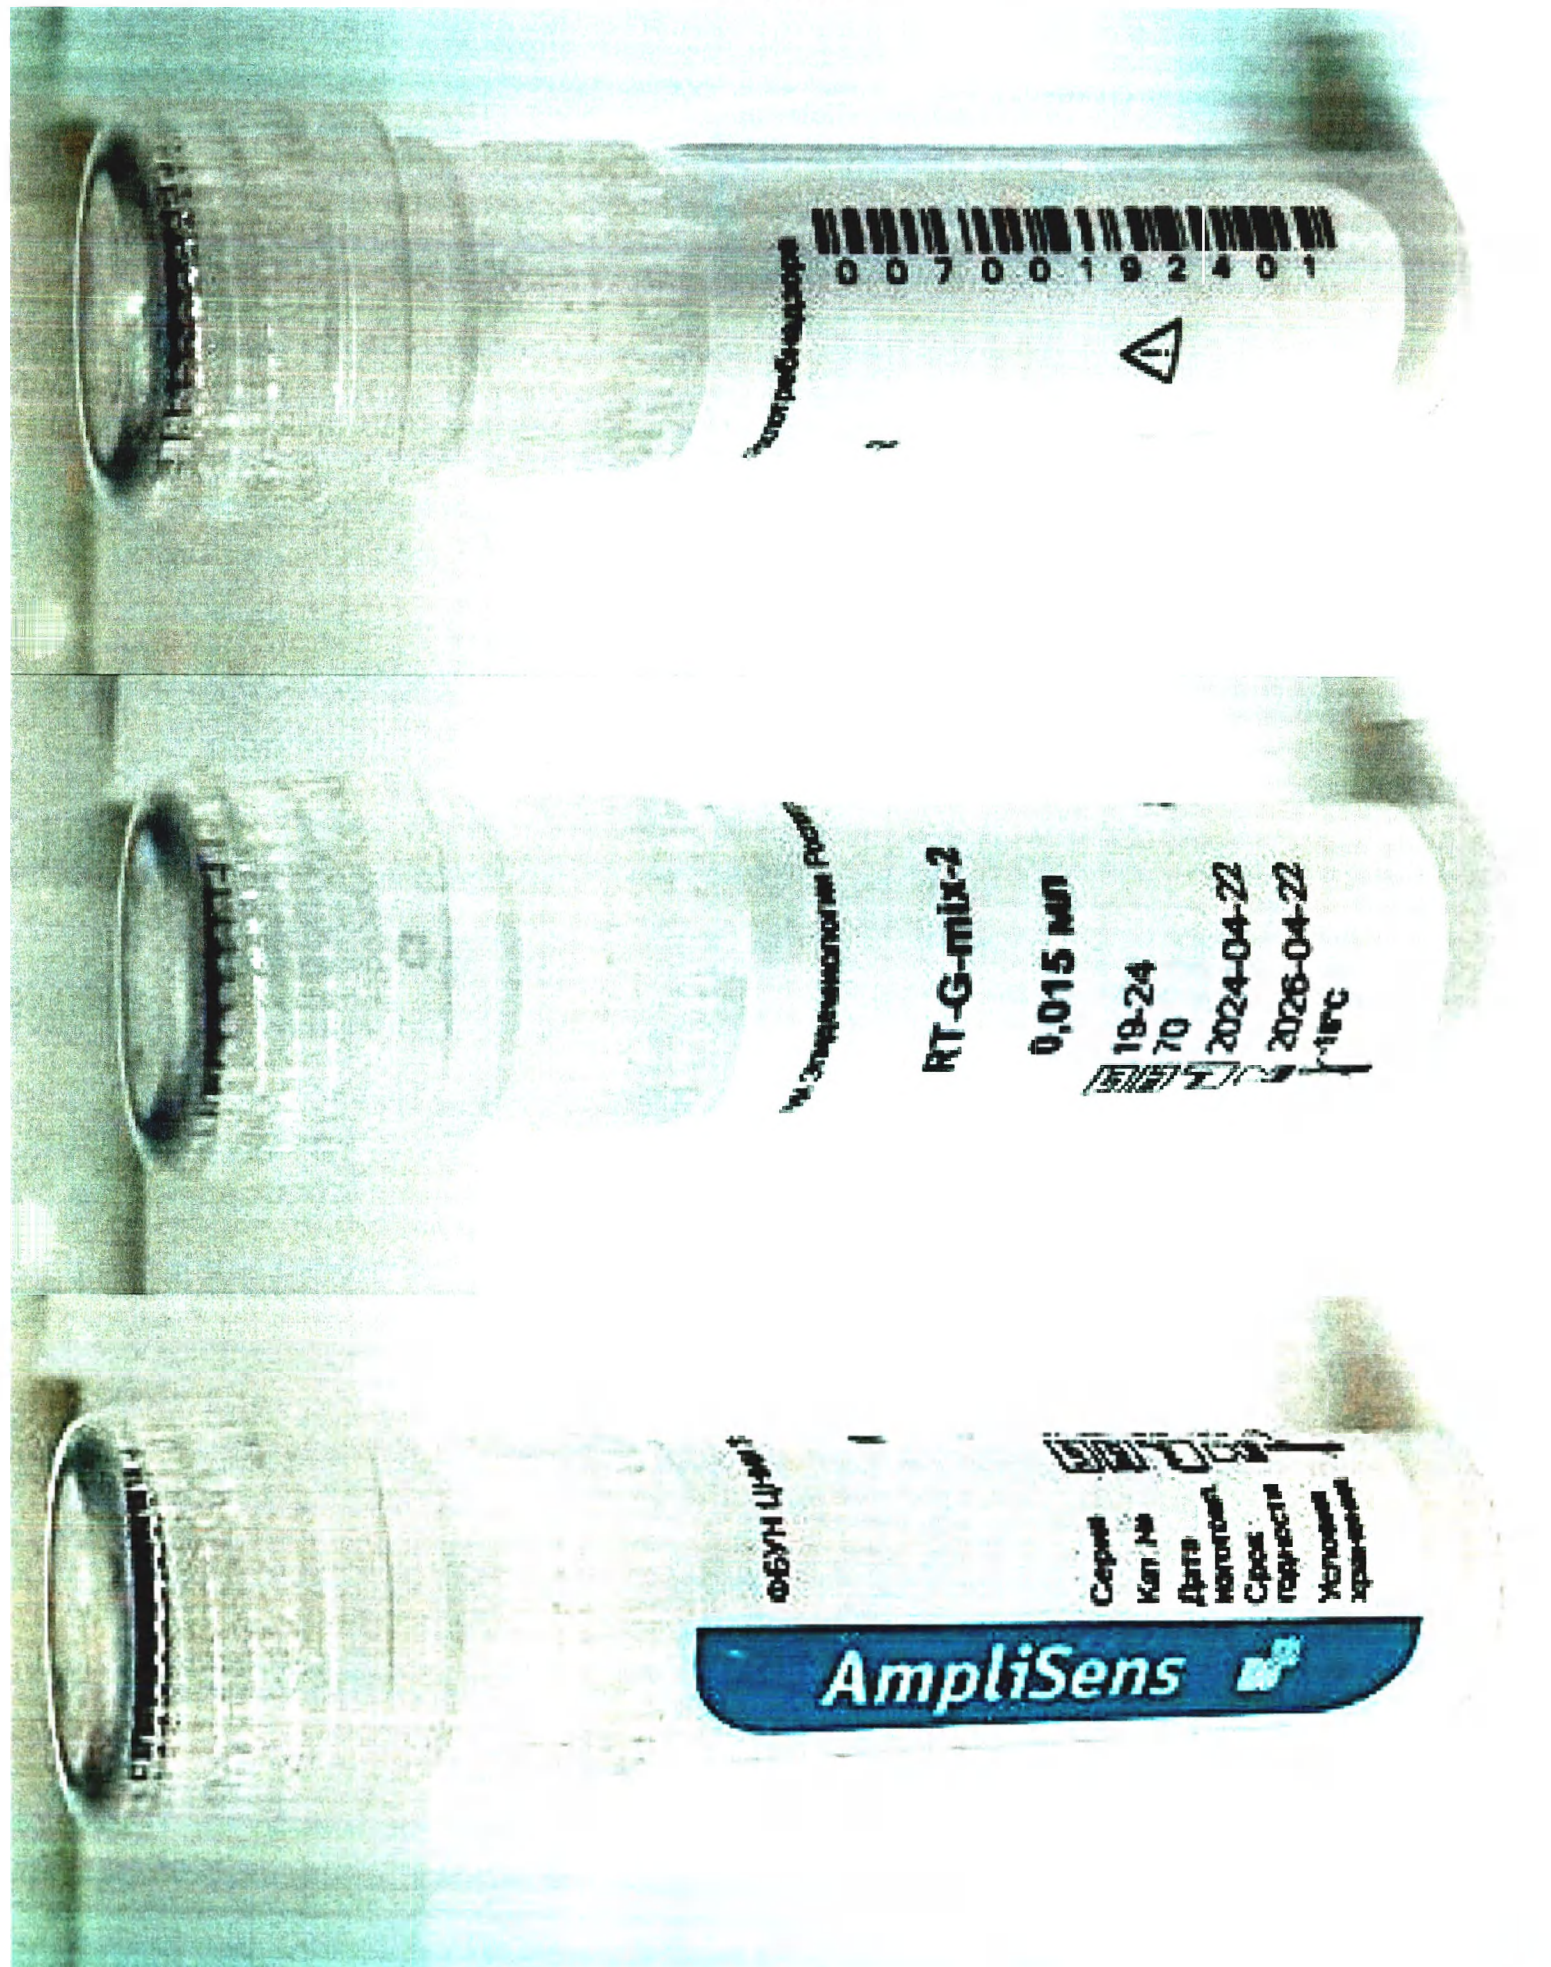


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
 ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
 ОТ-ПЦР-смесь-2-FL



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
Полимераза (TaqF)

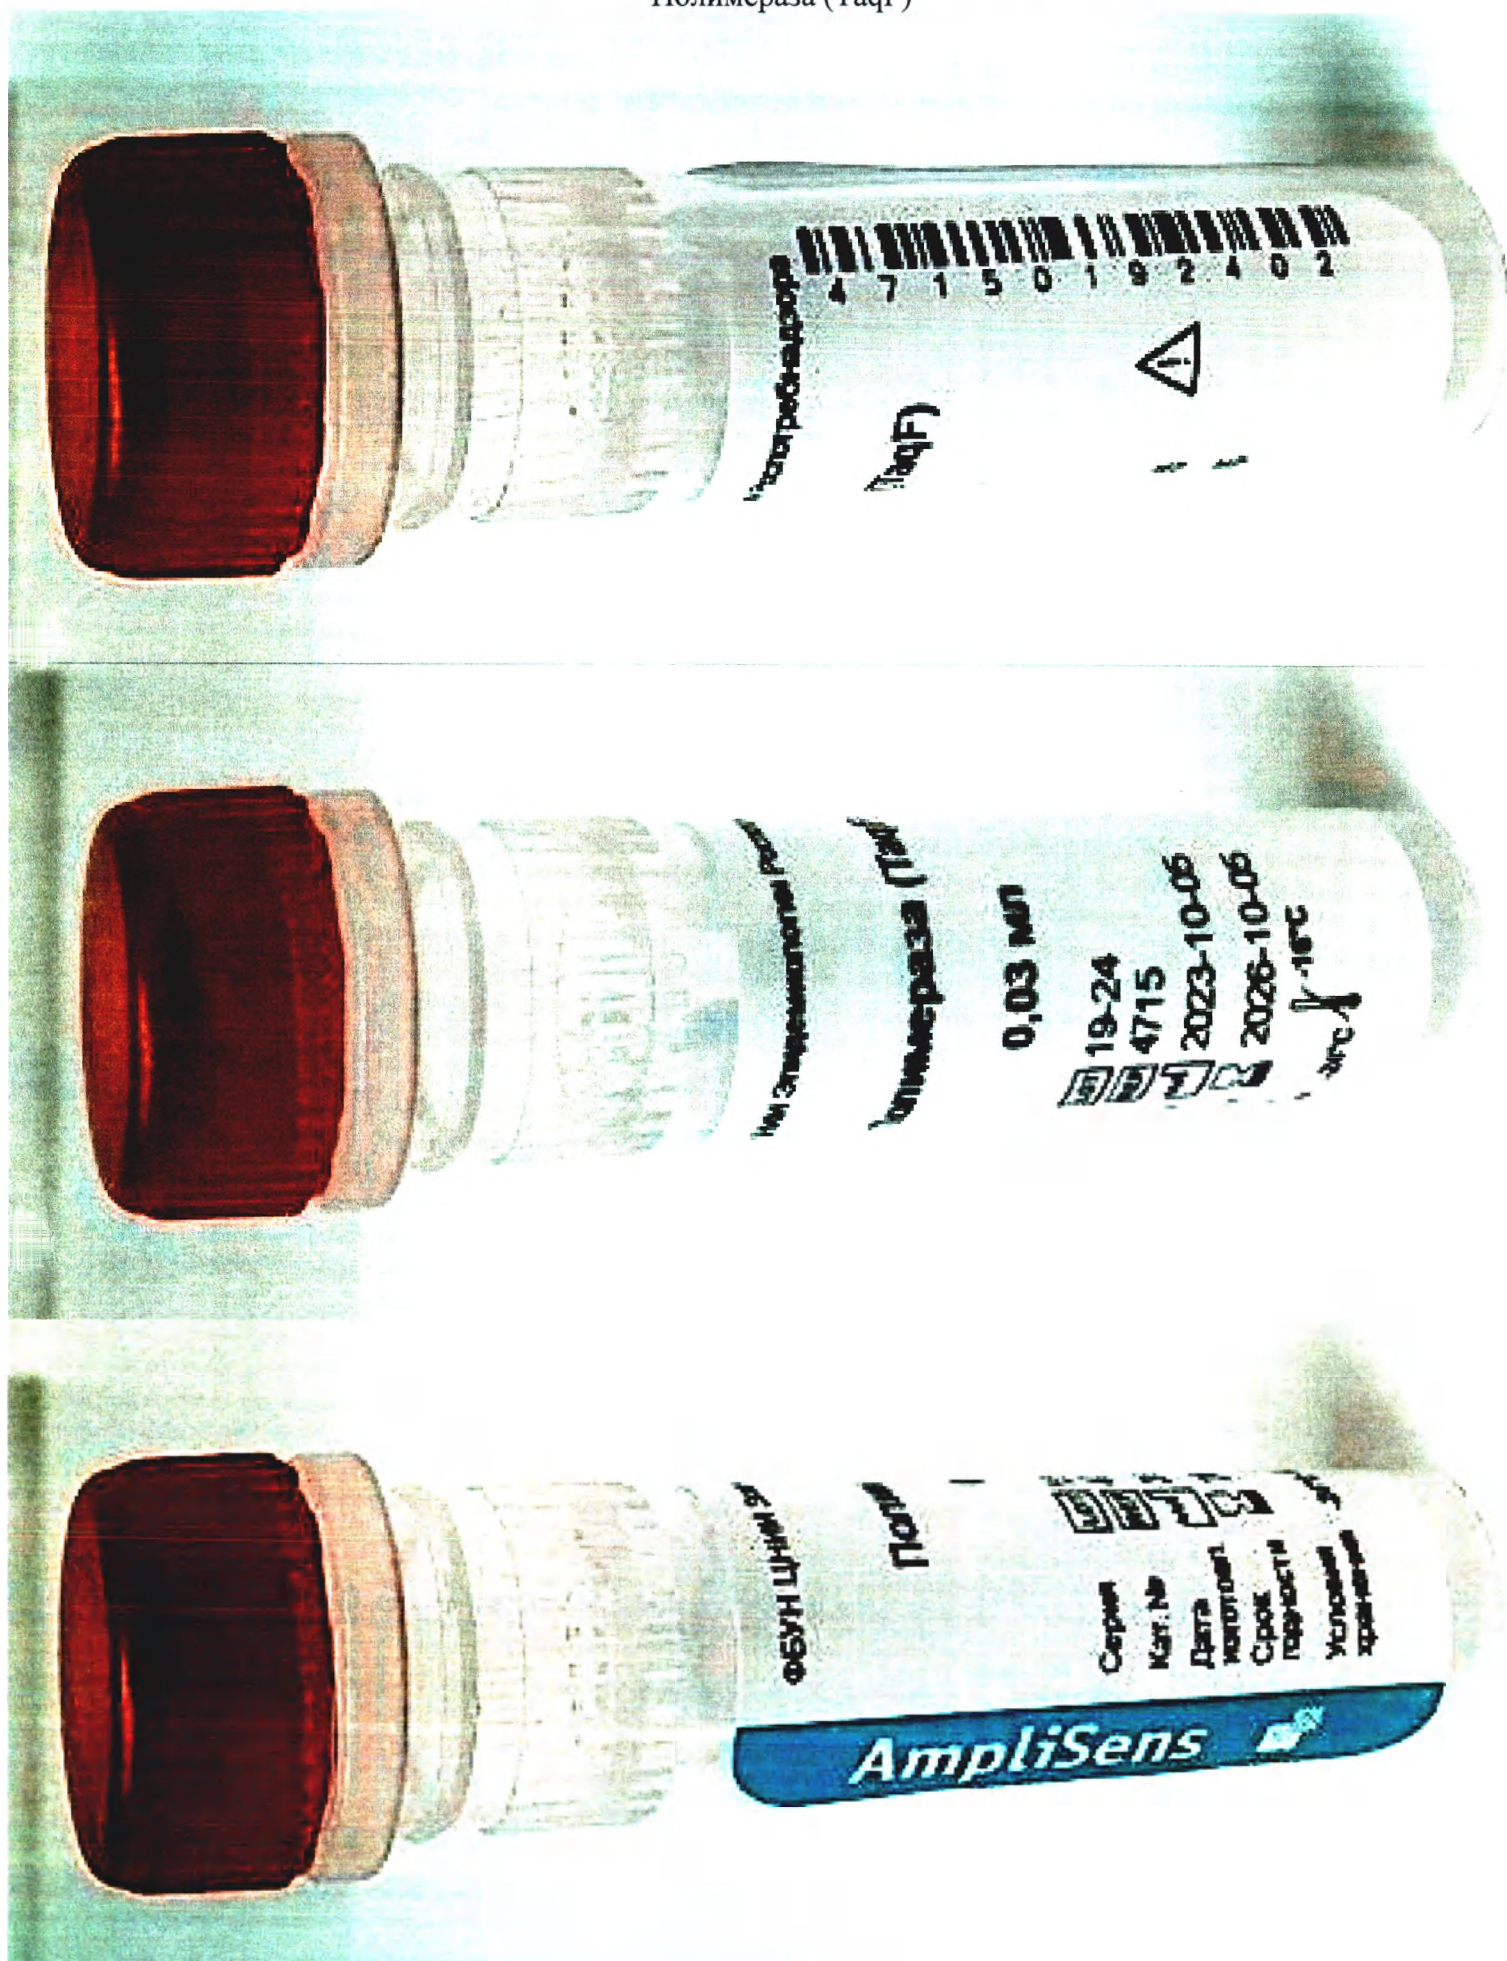


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2. ТМ-Ревертаза (MMIv)

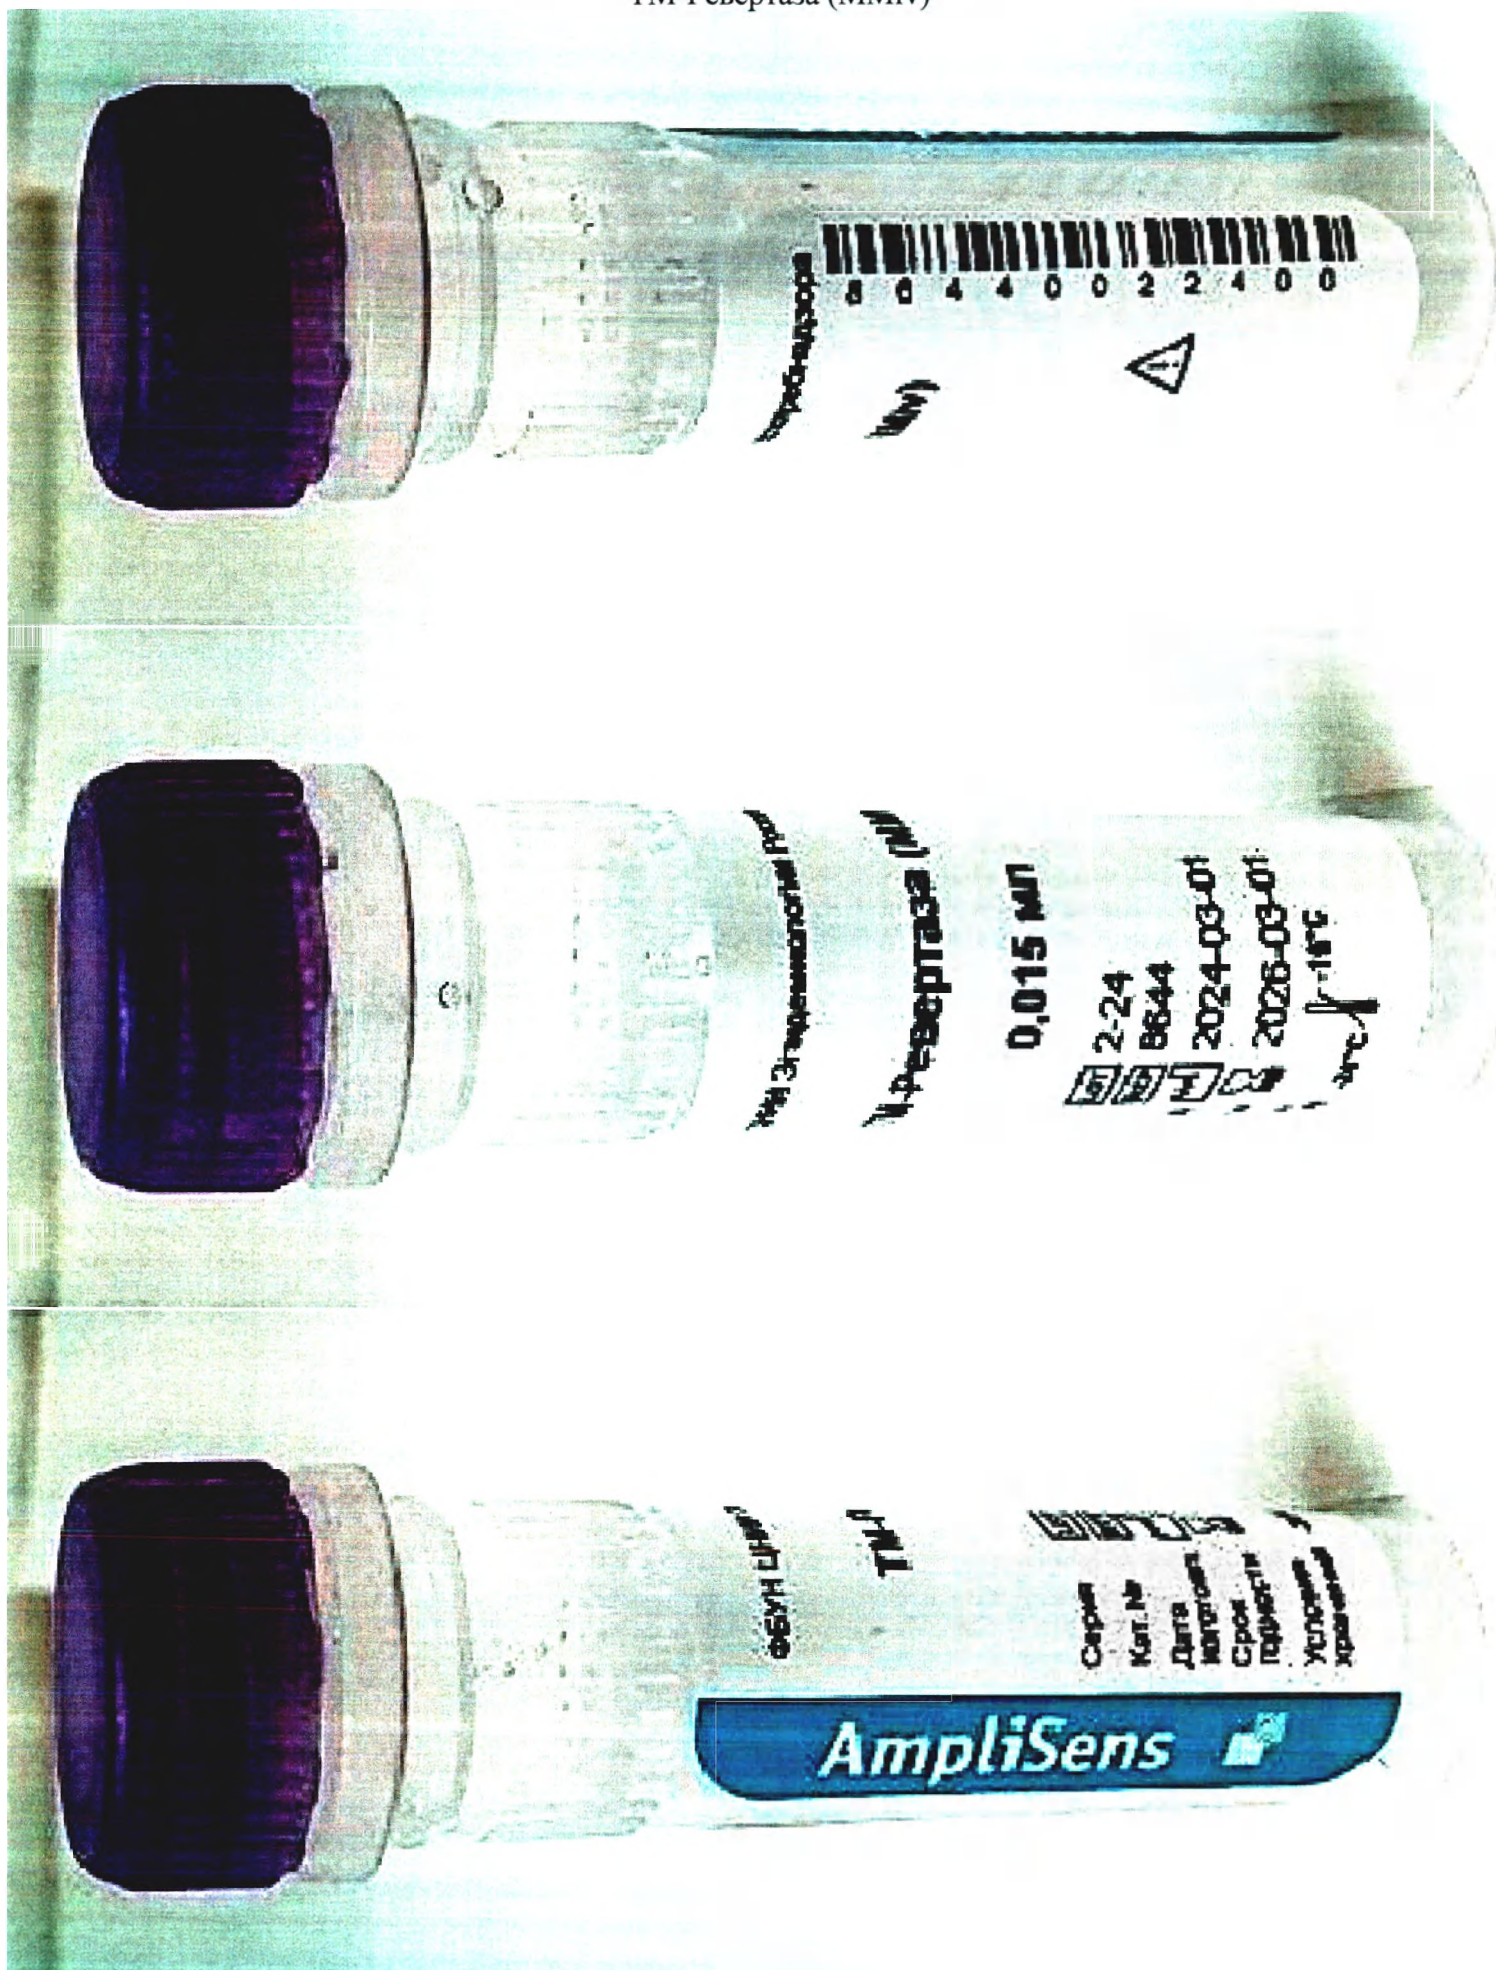



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.

Буфер для элюции, ПКО кДНК HCV / HBV / HIV



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT. Состоит из 2 частей. Реагенты части 2.
Буфер для элюции



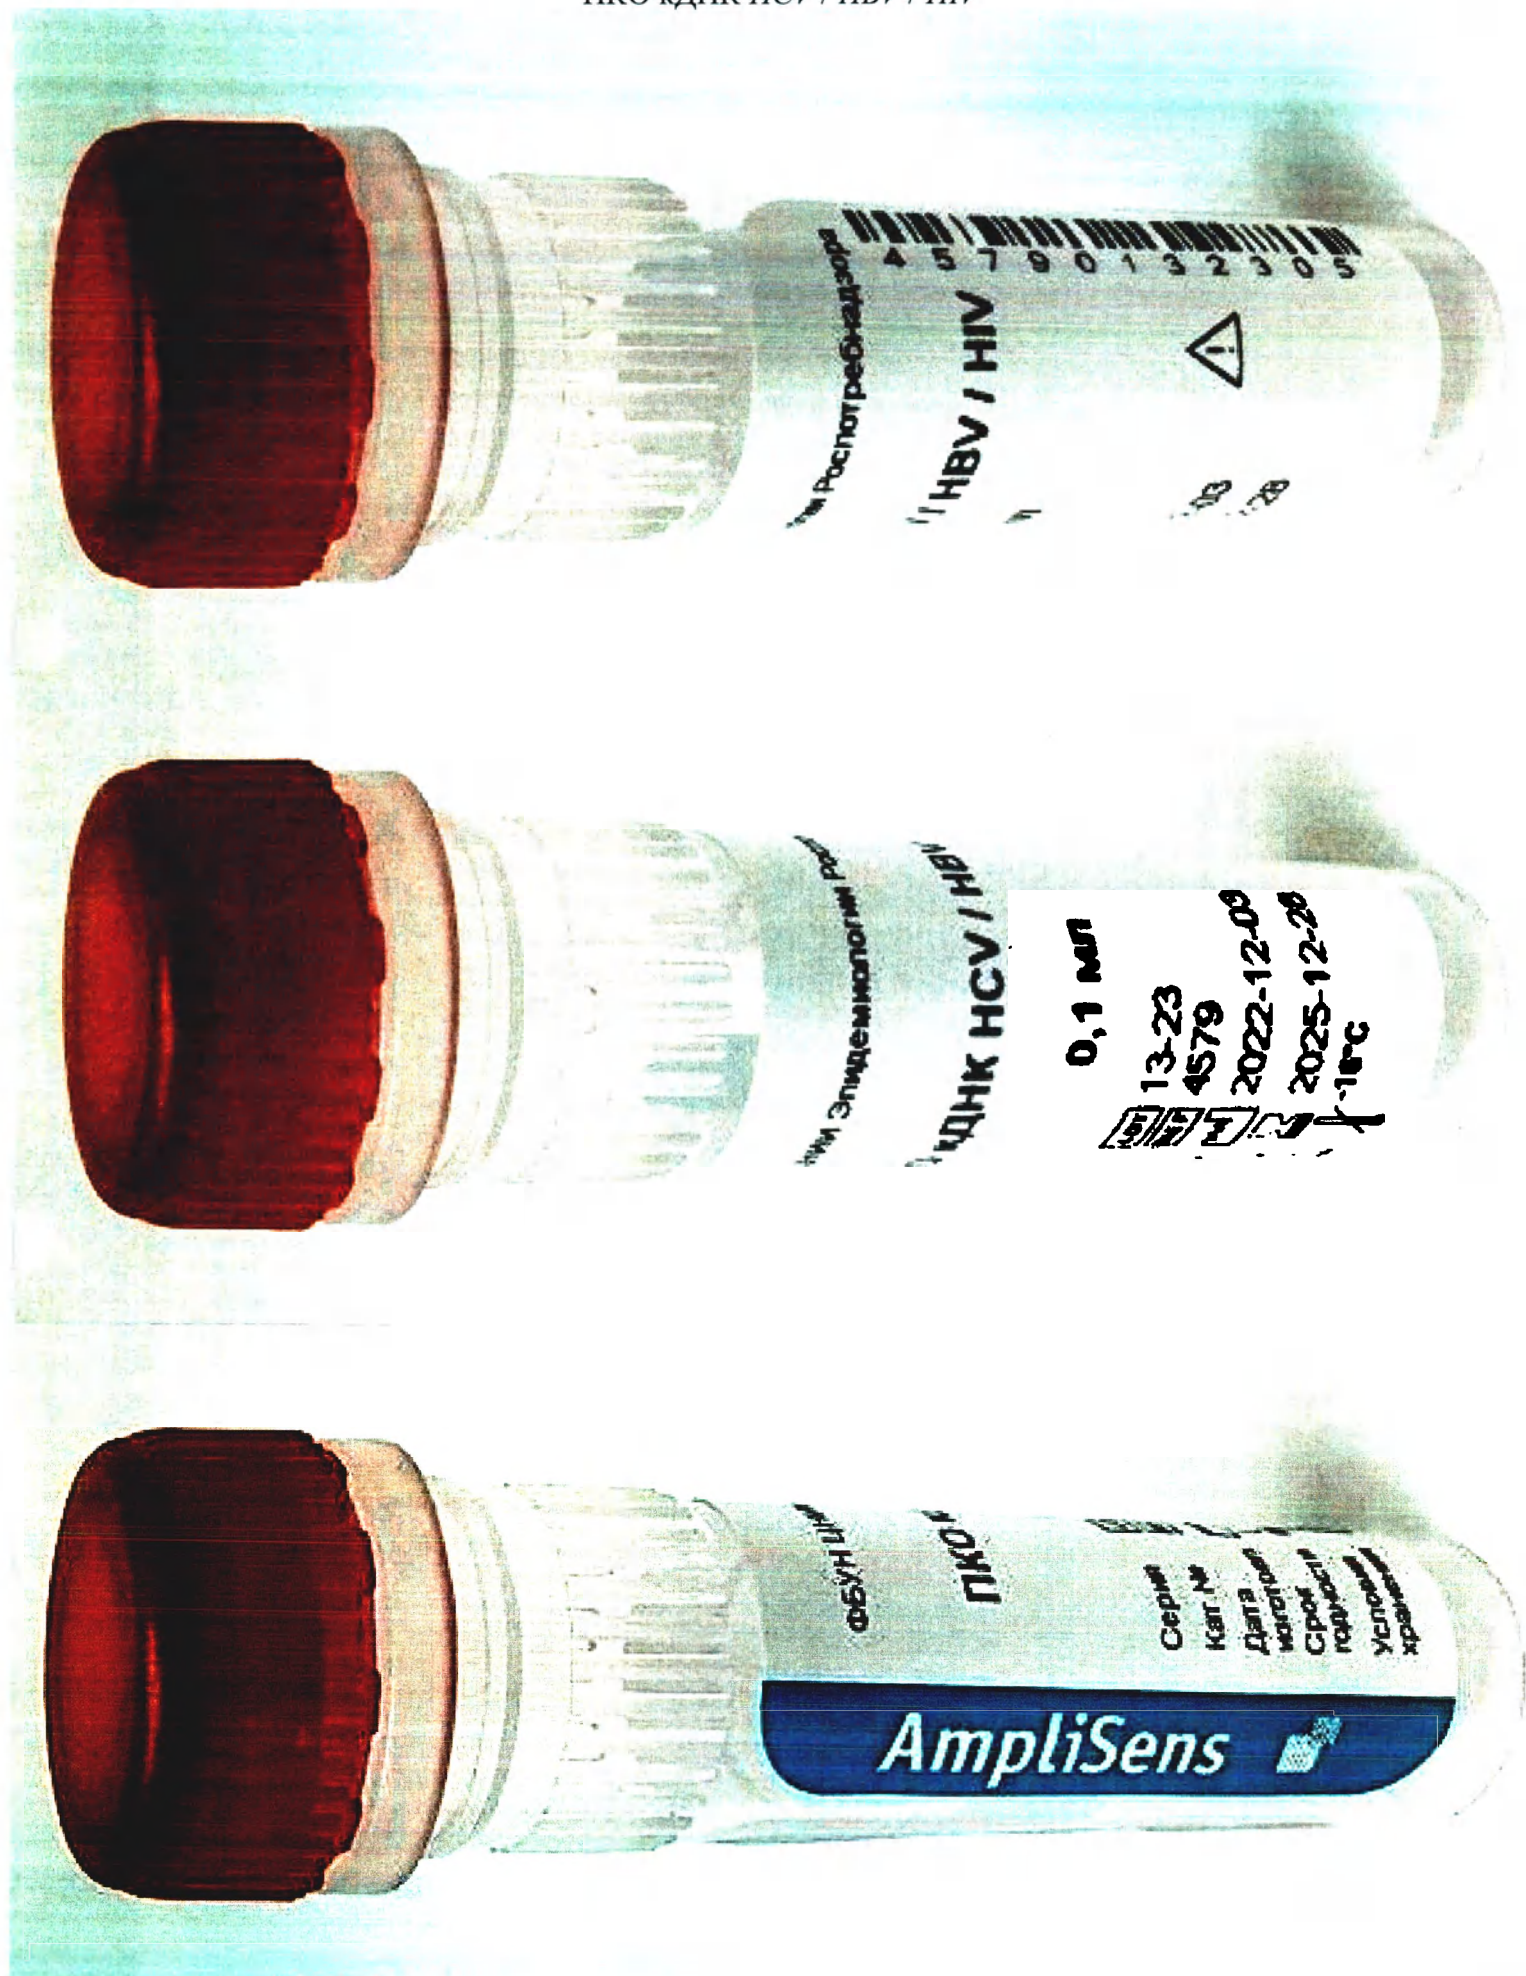



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV),
ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита
человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Формы 1, 2

Программное обеспечение
AmpliSens® Немо-screen Soft 5х версия 1.0.1

Руководство оператора

REF HK3-3521-1

REF H-3522-1

ТУ 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер:



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2	0,3 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
ТМ-Ревертаза (MMIv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО «ДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ЭКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО ST1-87-rec	0,5 мл x 4 шт.

100

-24 °C -16 °C



OT-ПЦР-смесь-1-FRT
HCV / HBV / HIV1 / HIV2
(www.amplisens.ru)

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):	1 шт.
AmpliSens® Hemo-screen Soft 5x версия 1.0.1	1 шт.
Руководство оператора	1 шт.
Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества	1 шт.
Вкладыш с настройками	1 шт.
Вкладыш для автоматизированной работы	1 шт.
Краткое руководство	1 шт.

REF H-3522-1

LOT 09.07.24


2024-07-09

2025-07-09

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
RU 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер:


Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT.
После вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock).

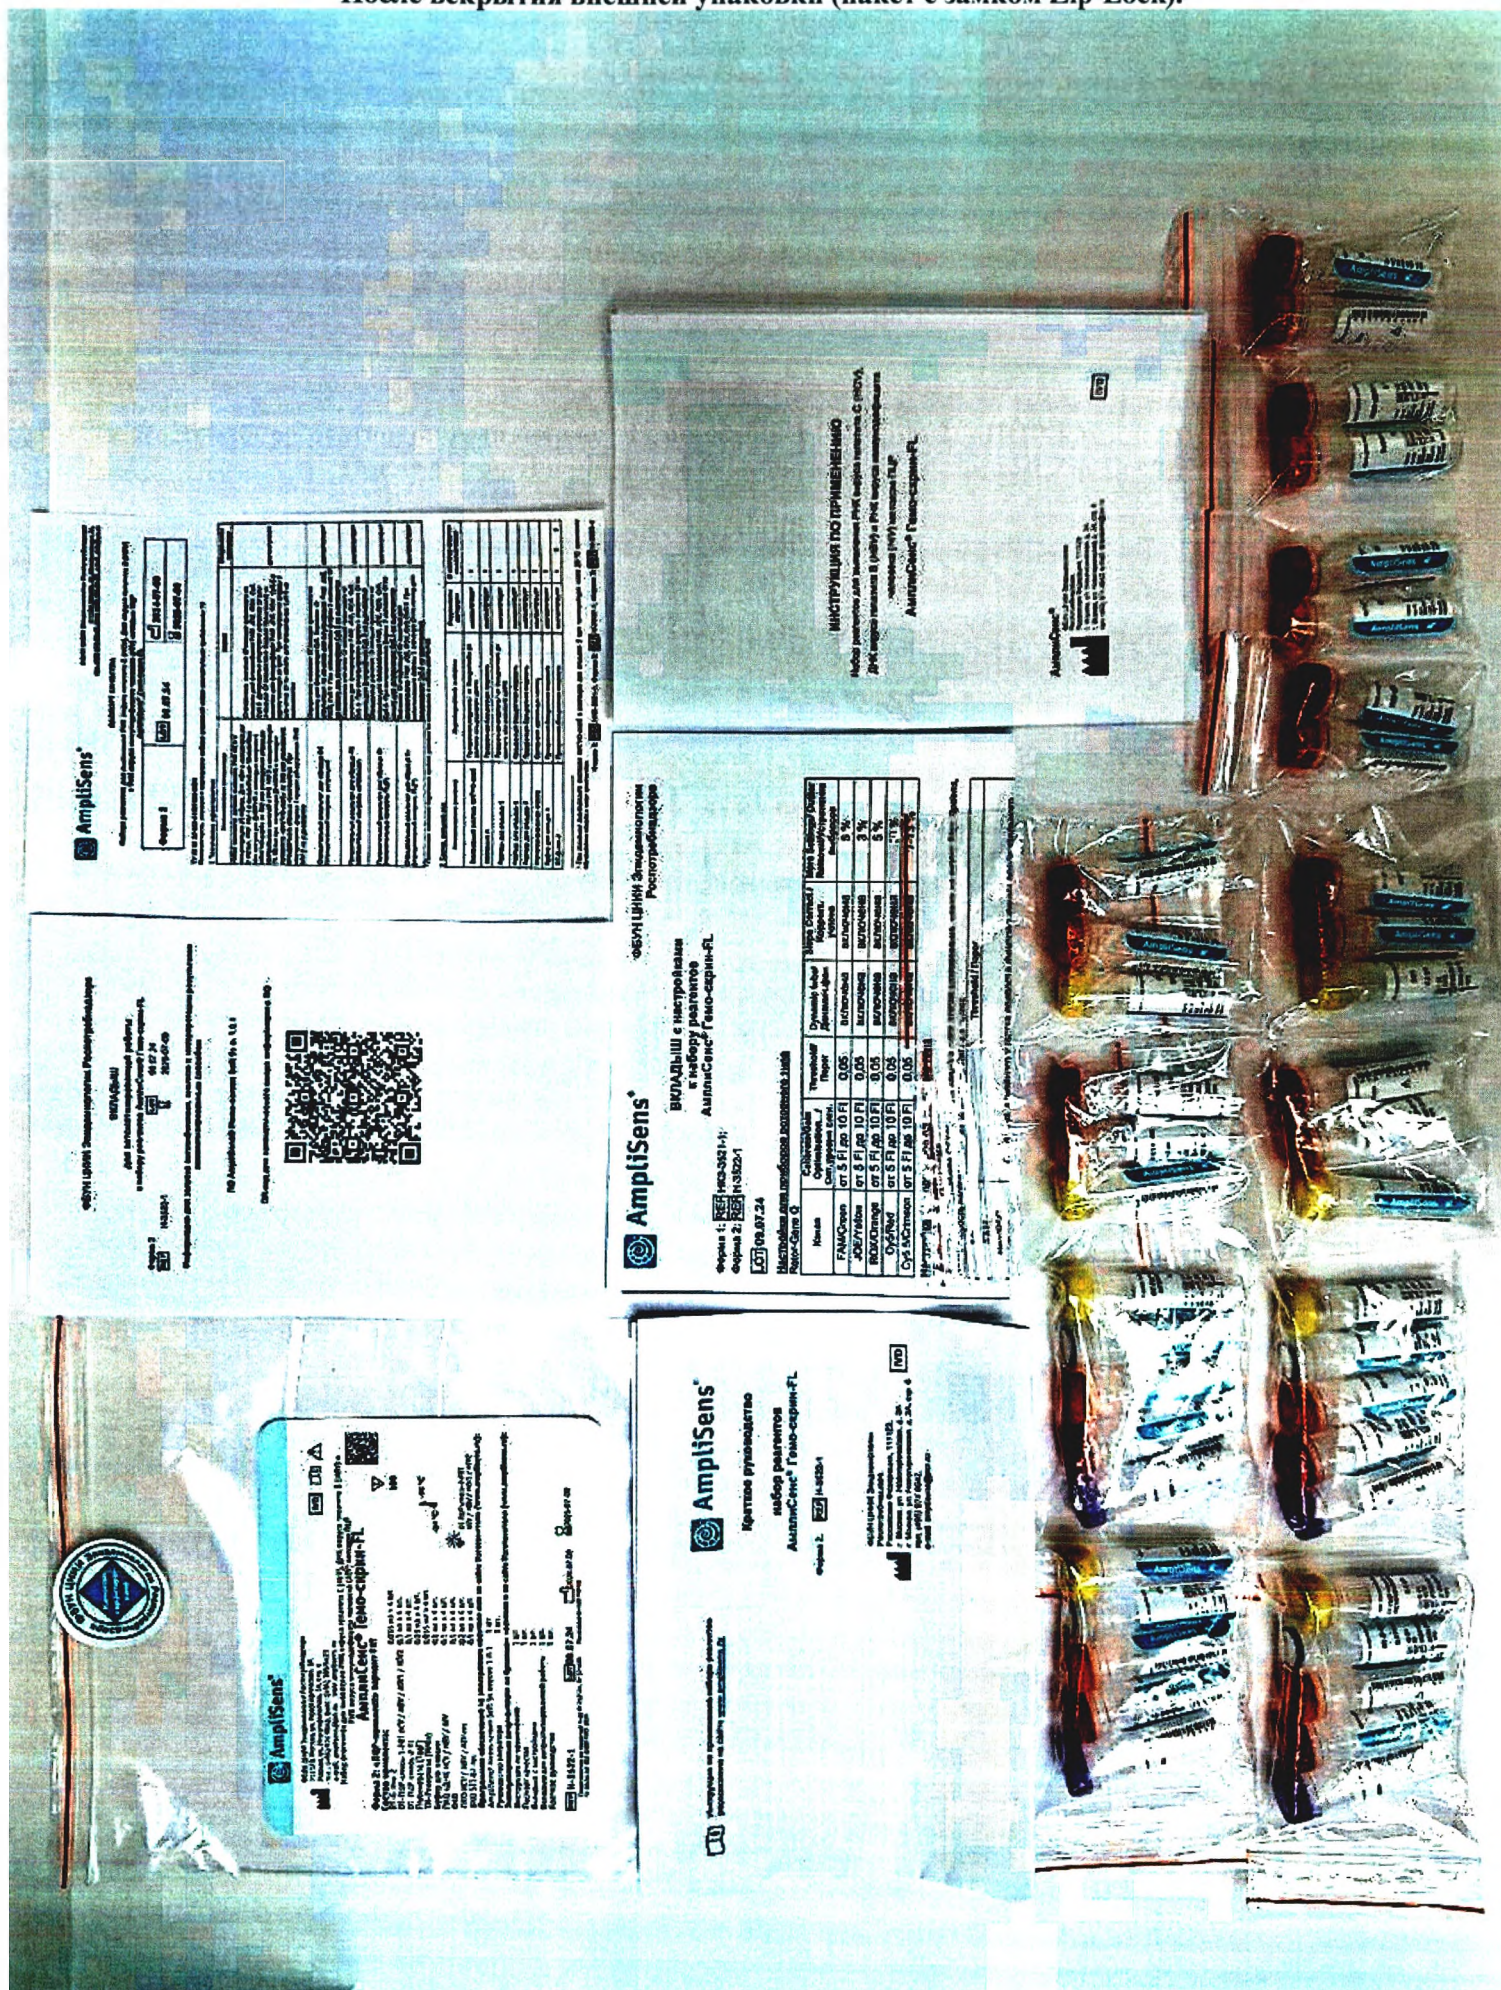



AmpliSens®

ФВУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
Тел: 774 9642, факс: (495) 305 5423
E-mail: amplisens@pccr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь 1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2	0,3 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь 2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
TM-Реввертаза (MMIV)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
РКО кДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
РКО	0,5 мл x 4 шт.
РКО HCV / HBV / HIV rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-тес	0,5 мл x 4 шт.

-24 °C
-16 °C

OT-ПЦР-смесь 1-FRT
HCV / HBV / HIV1 / HIV2

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

AmpliSens® Hemo screen Soft 5x версия 1.0.1	1 шт.
Руководство оператора	1 шт.
Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):	
Инструкция к приложению	1 шт.
Паспорт качества	1 шт.
Задачник с настройками	1 шт.
Задачник для автоматизированной работы	1 шт.
Числовое руководство	1 шт.

4-3522-1

Адрес: Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
Тел: 774 9642, факс: (495) 305 5423


LOT 09.07.24


2774, IP 121480

Регистрационный номер:

2024-07-09

2025-07-09

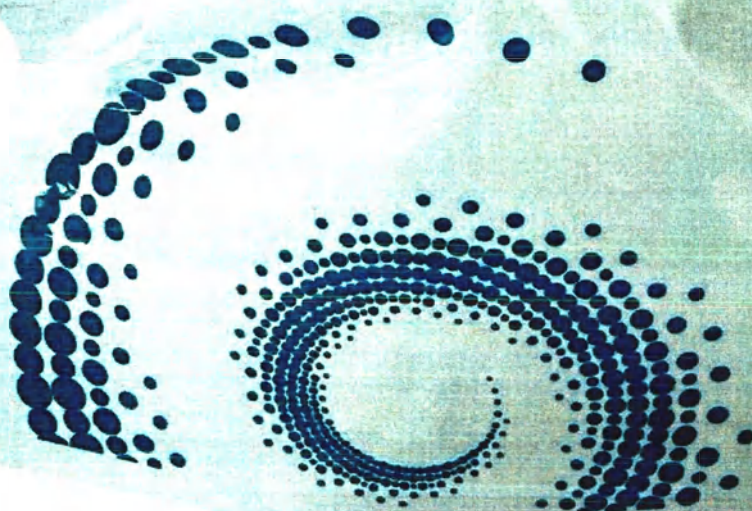

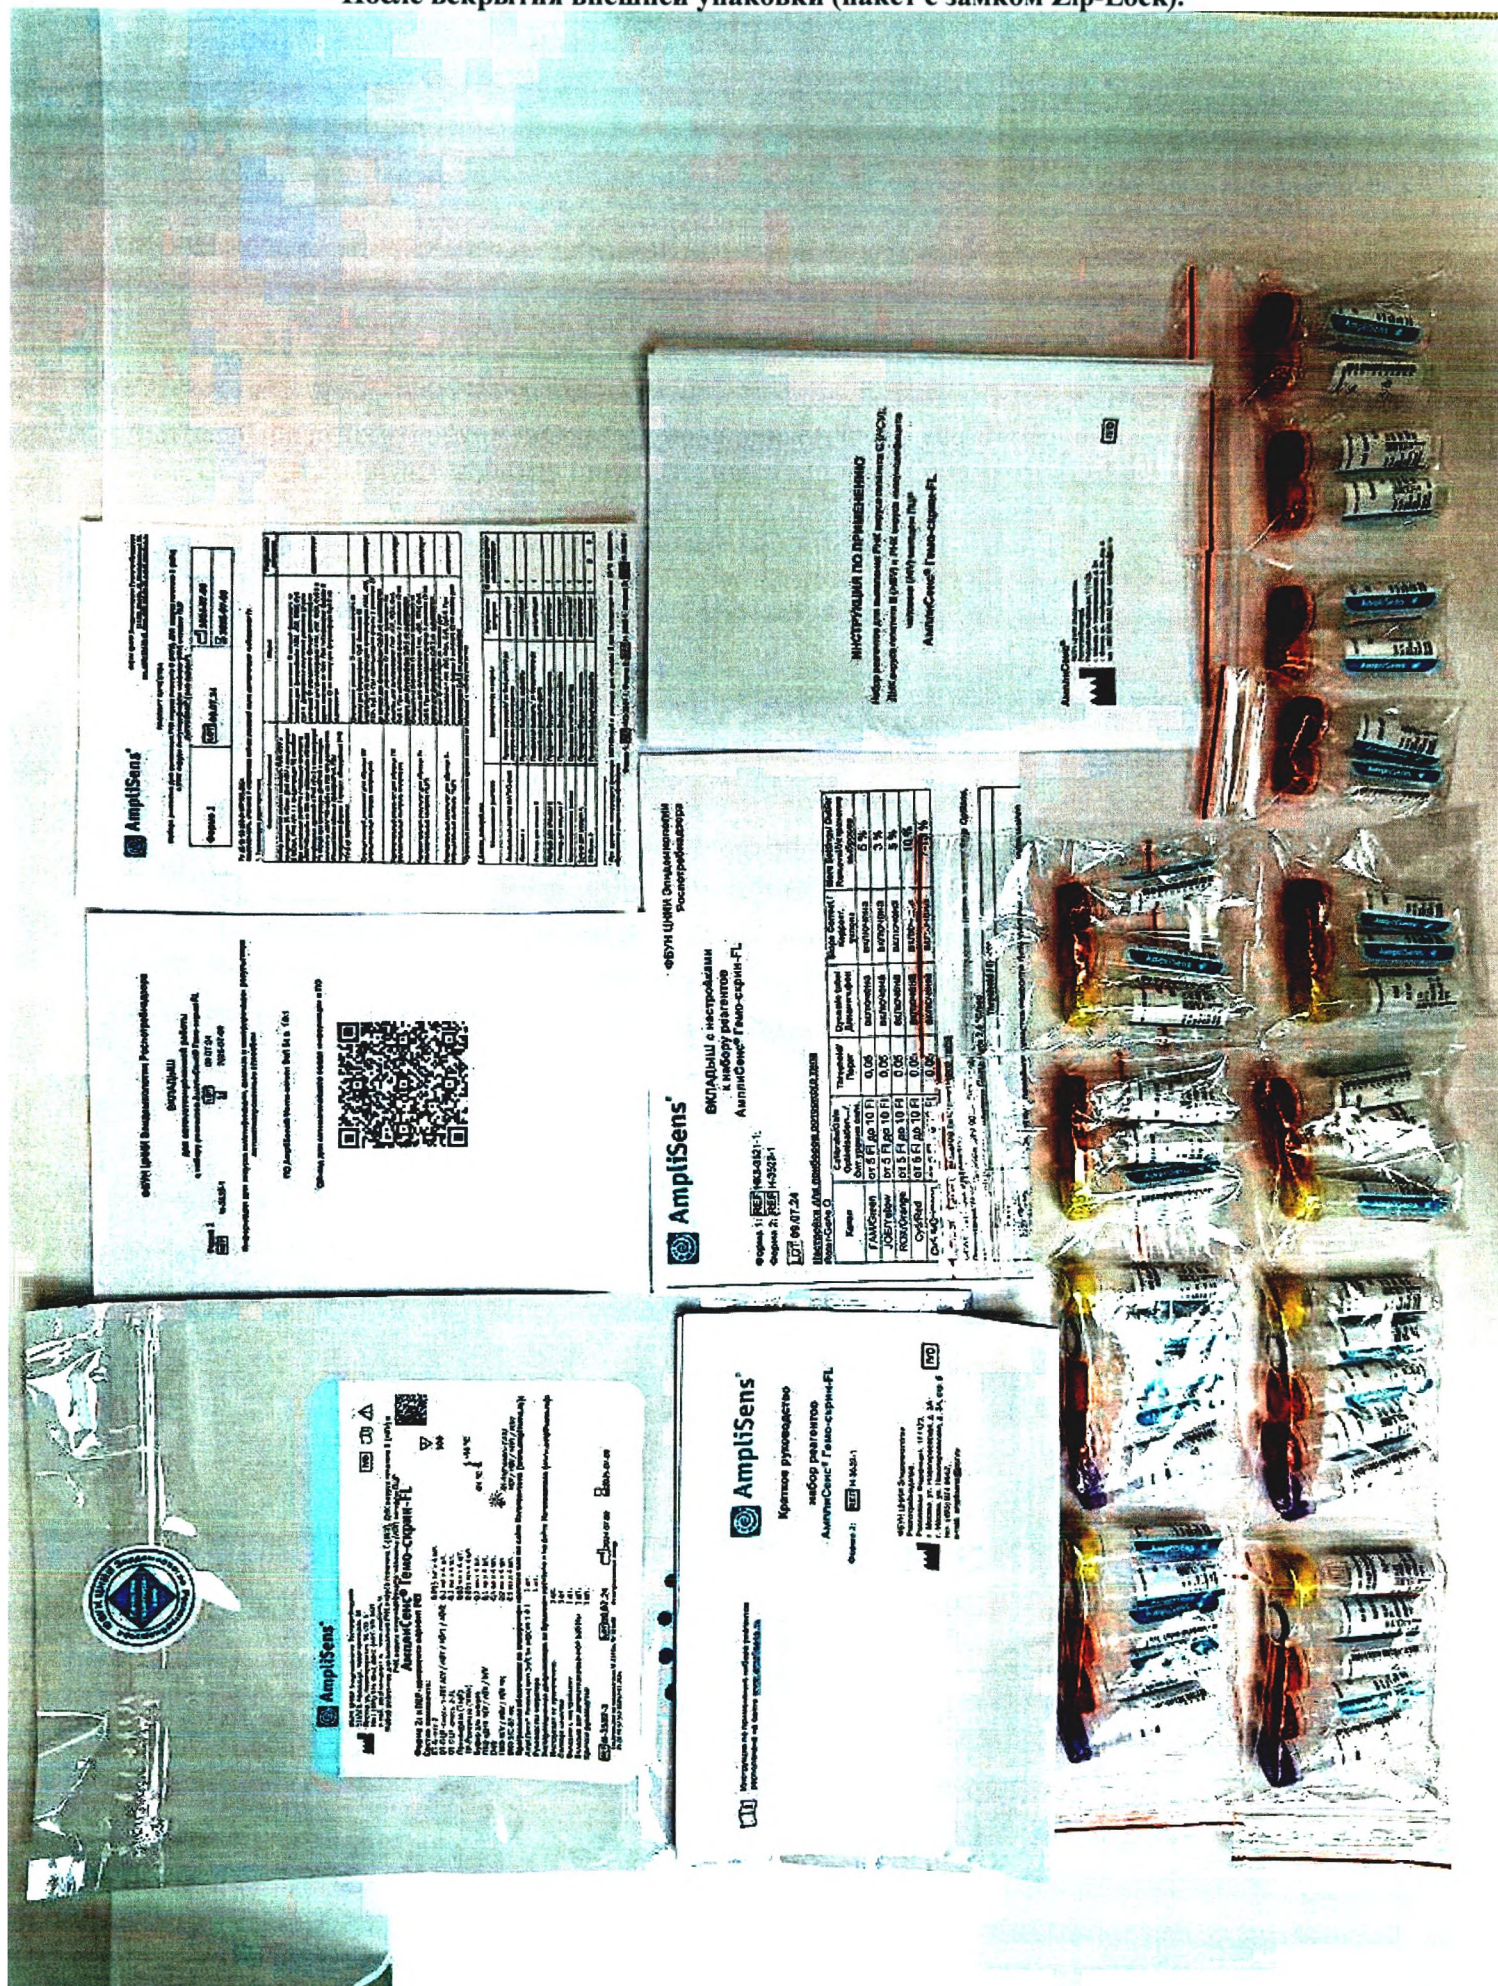



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2	0,3 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
ТМ-Реввертаза (MMIv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО «ДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-rec	0,5 мл x 4 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

AmpliSens® Немо-screen Soft 5x версия 1.0.1 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Вкладыш с настройками 1 шт.

Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.

REF H-3522-1

LOT A09.07.24

2024-07-20

2025-07-09

Сертификат на товарный знак № 212724, № 321400
RU 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер

Фото набора реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT.
После вскрытия внешней упаковки (коробка).



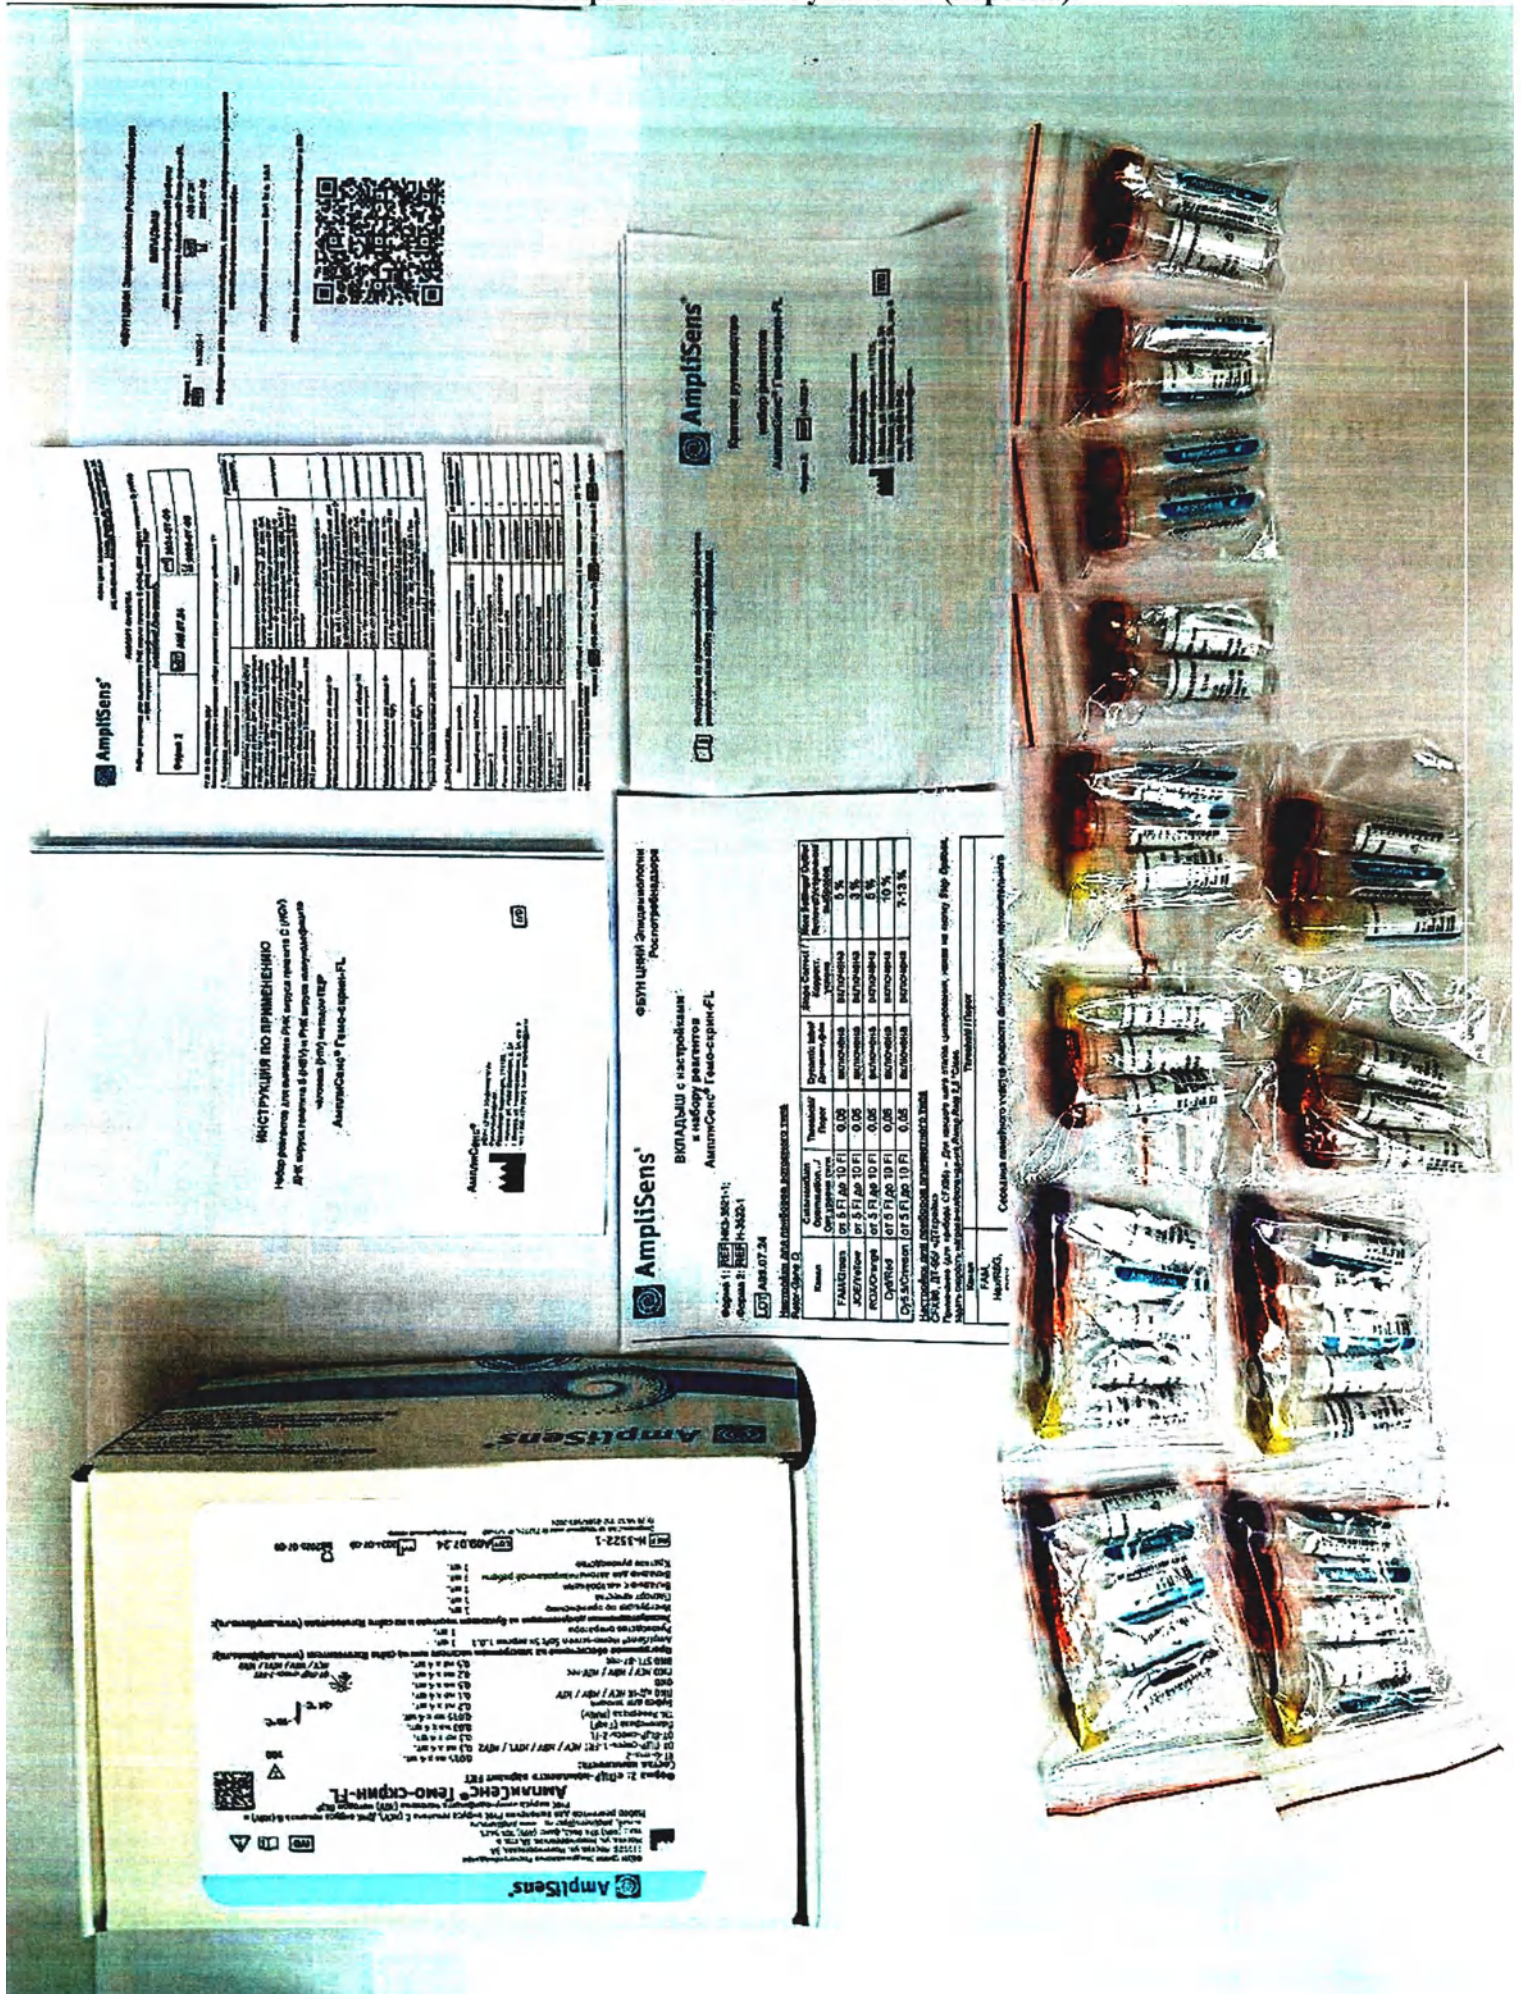


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

RT-G-mix-2, ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2, ОТ-ПЦР-смесь-2-FL, Полимераза (TaqF), ТМ-Ревертаза (MMLv)

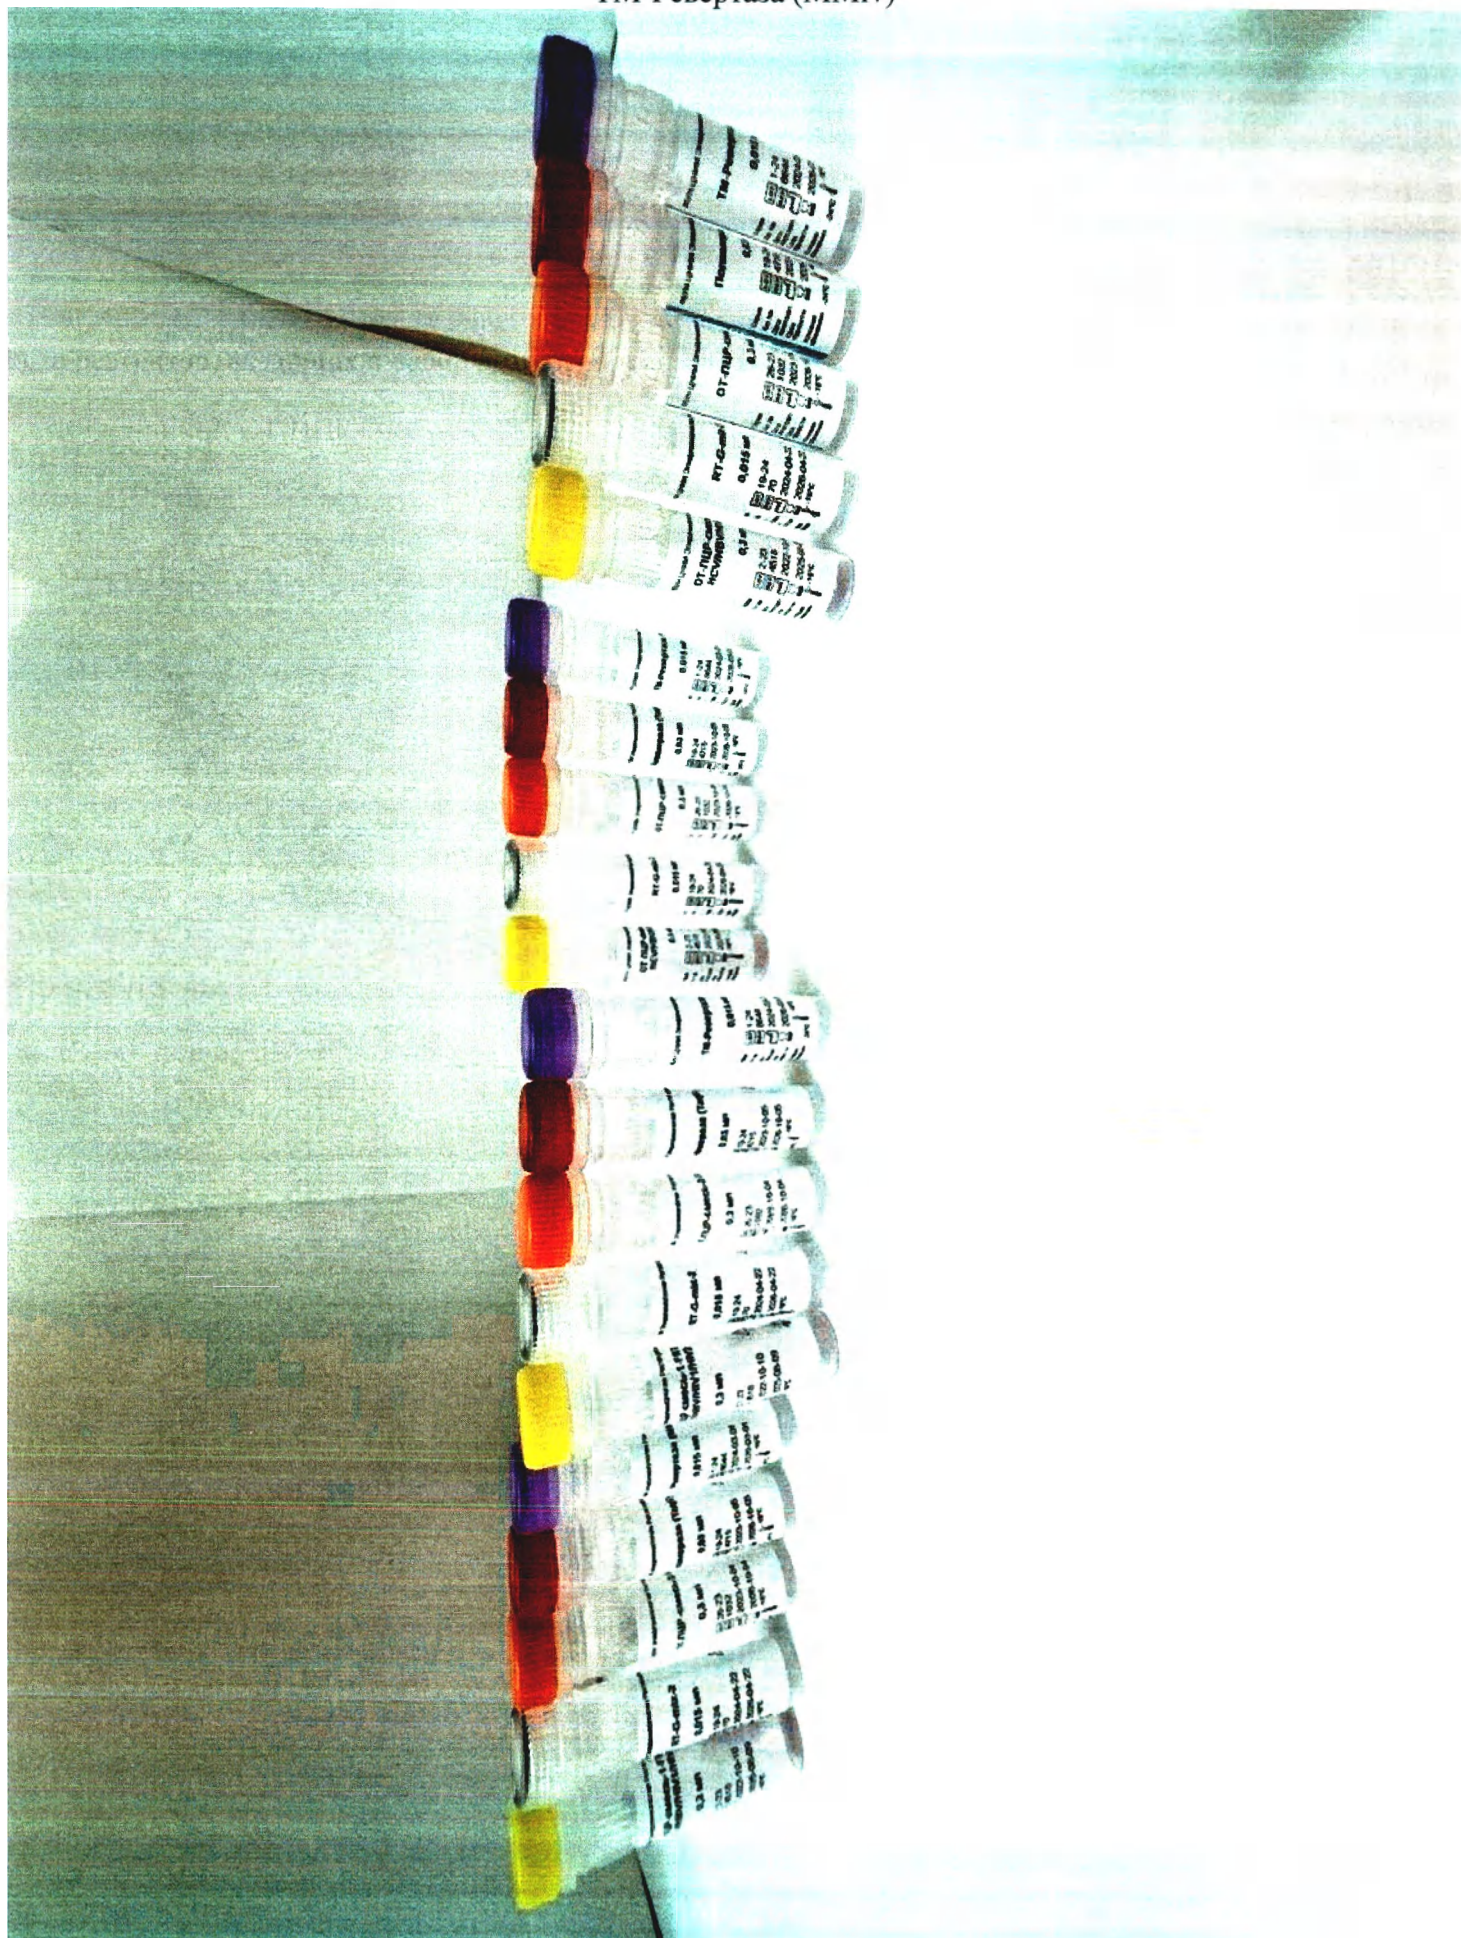

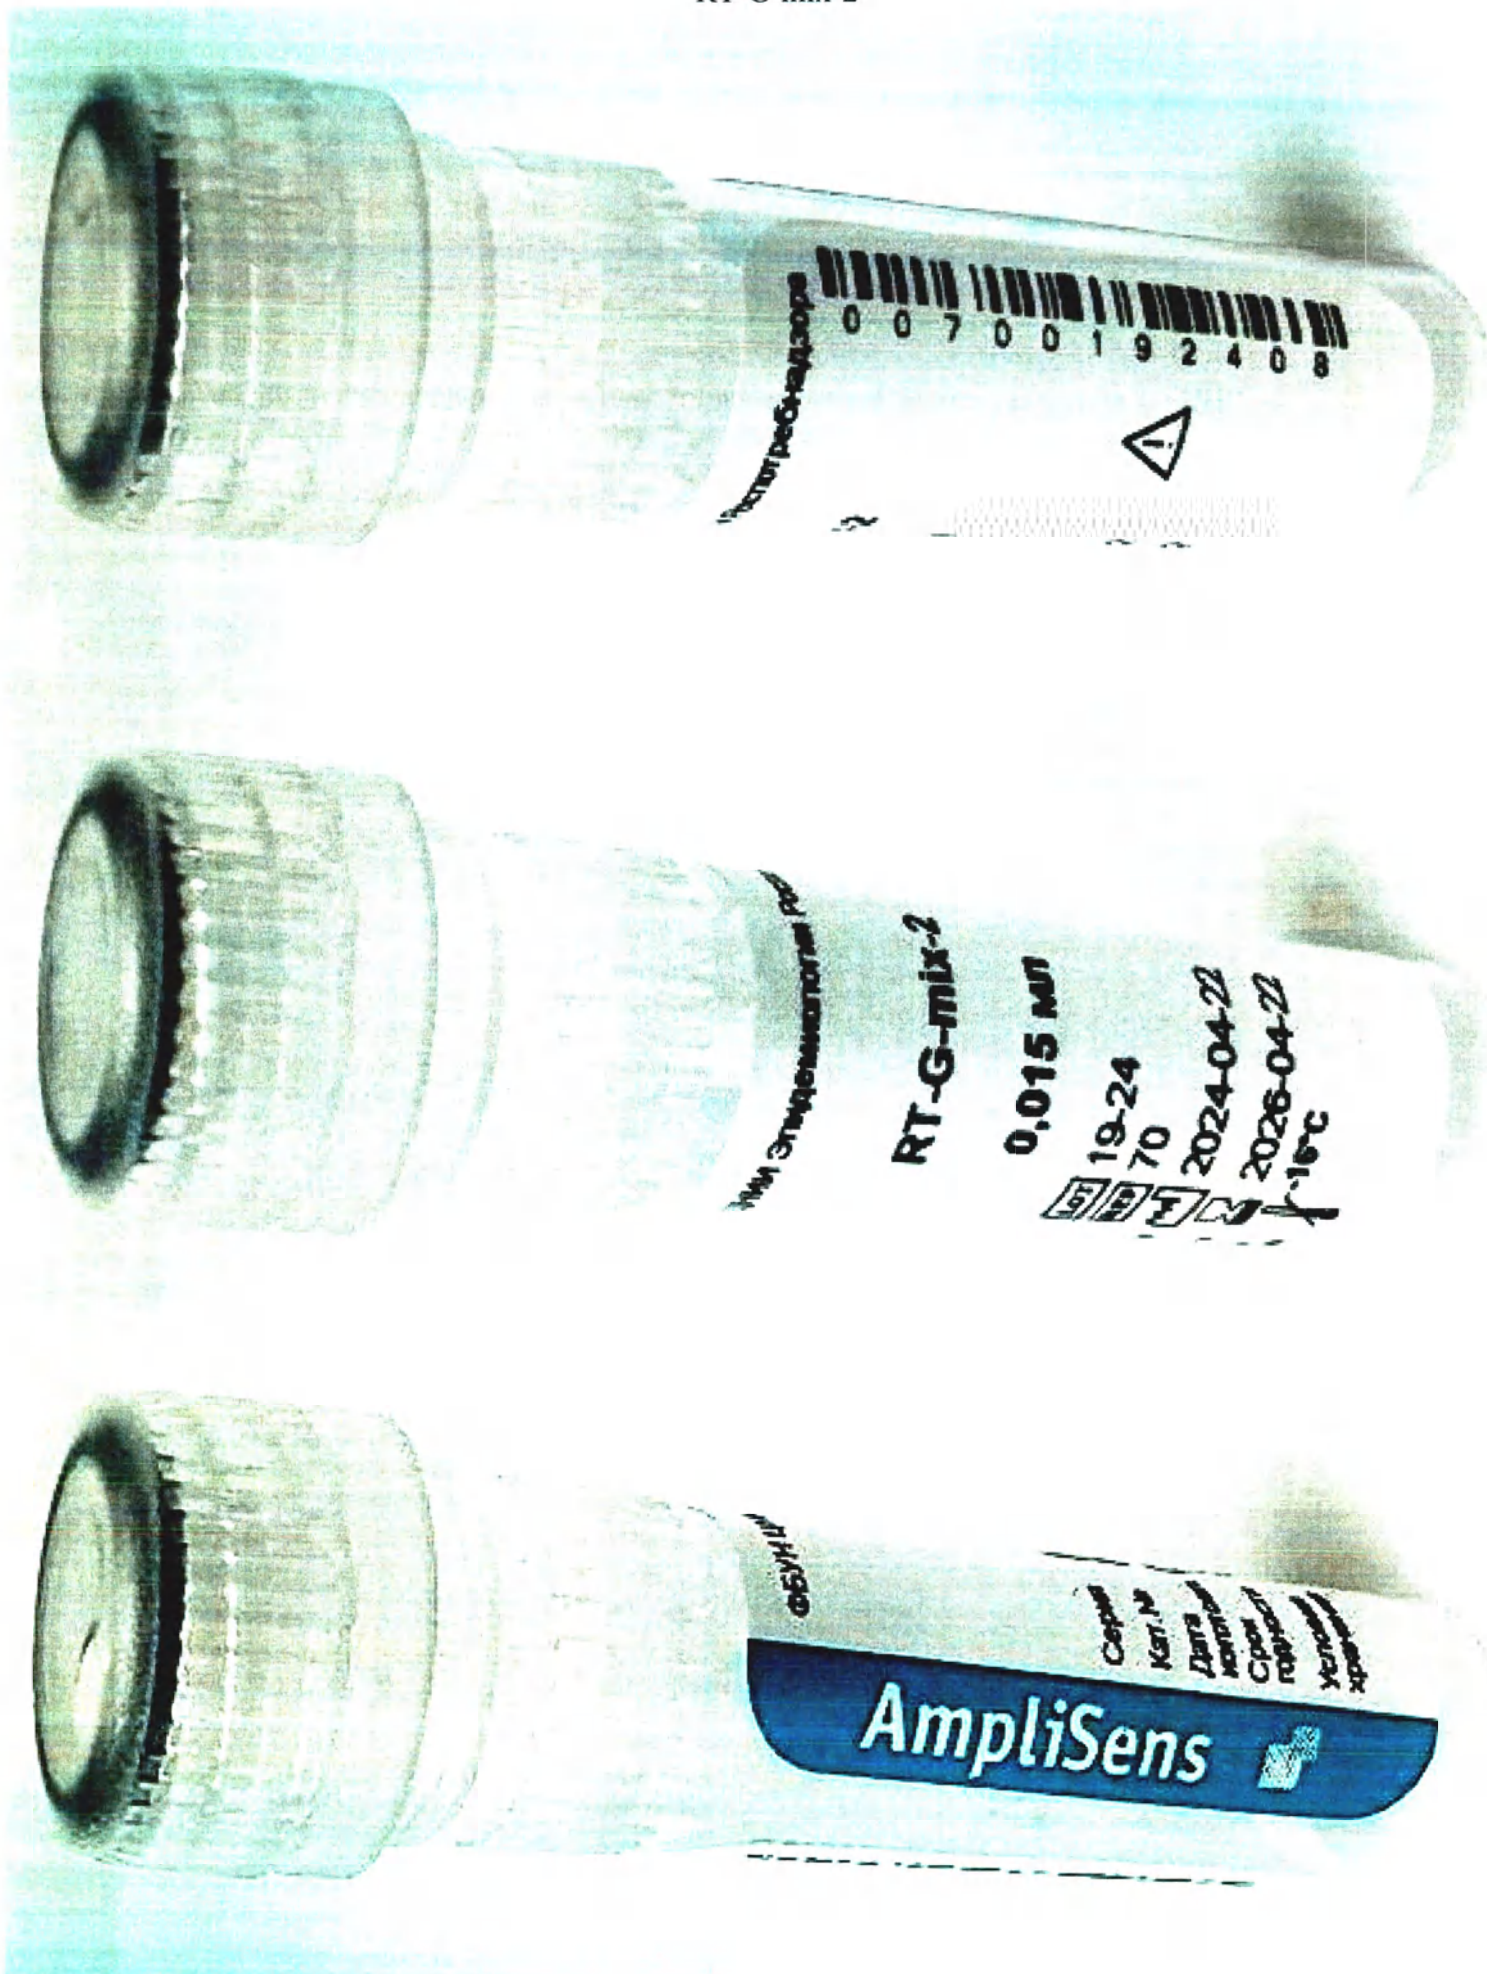




ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2





Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT
Полимераза (TaqF)



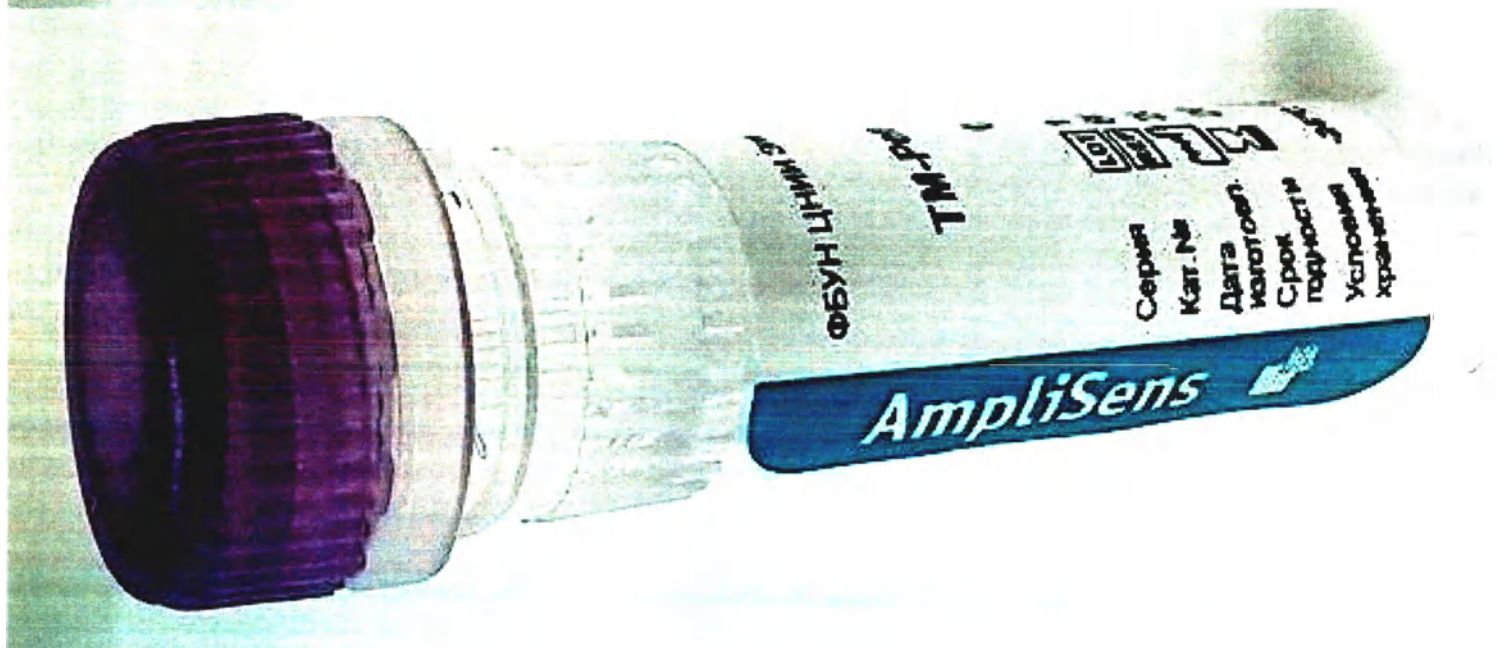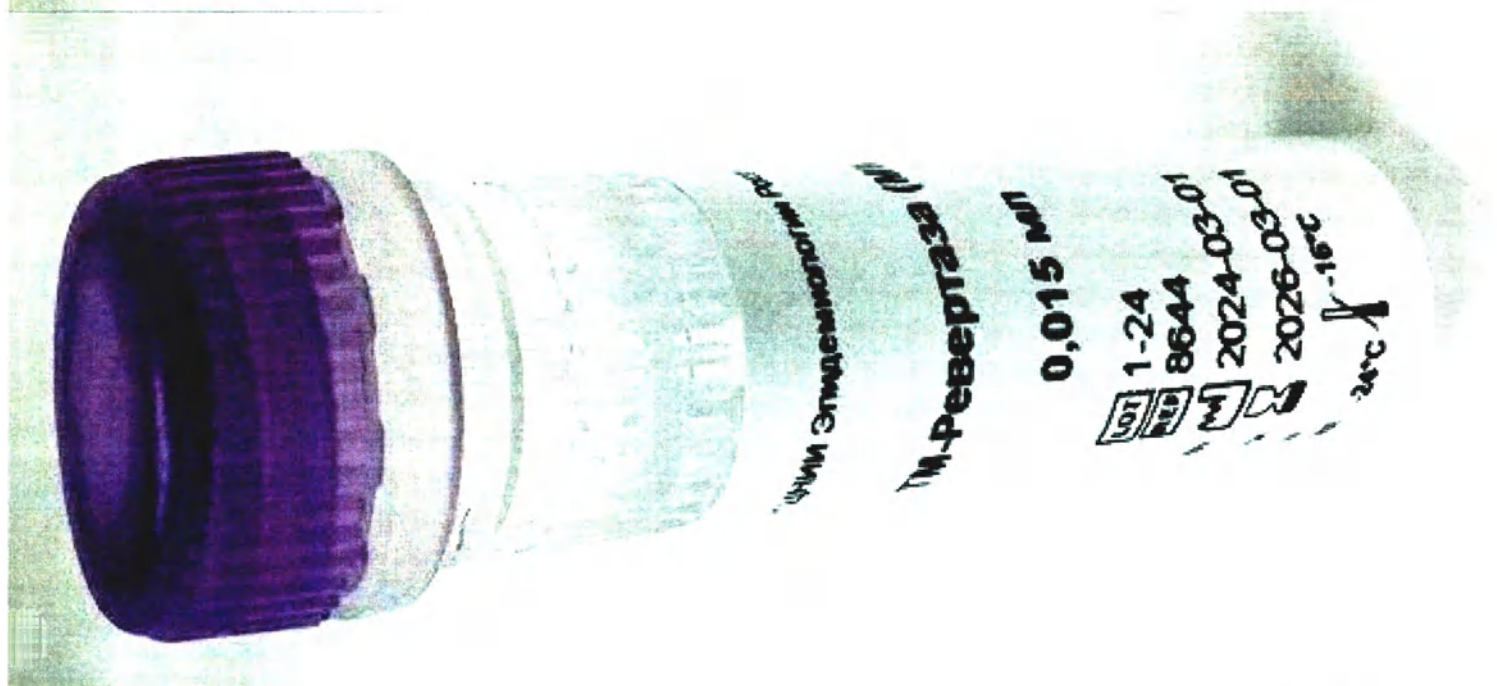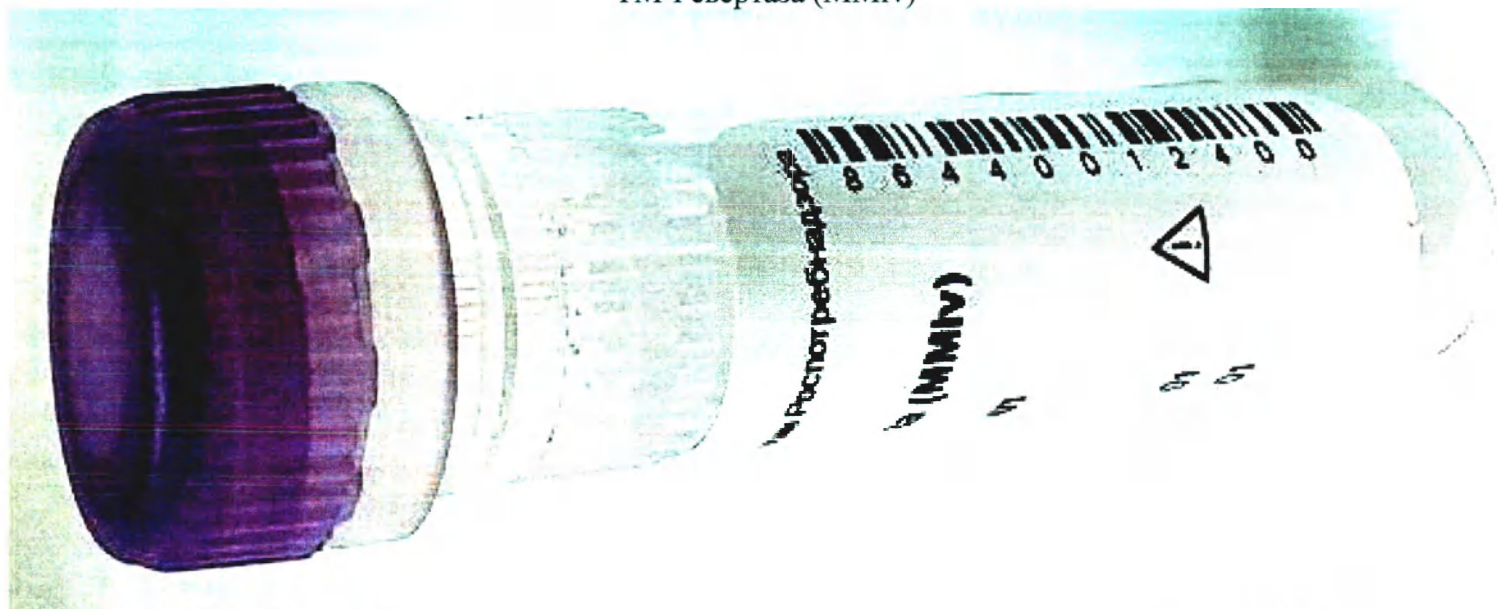

ОКО, ПКО HCV / HBV / HIV-rec, ВКО STI-87-rec



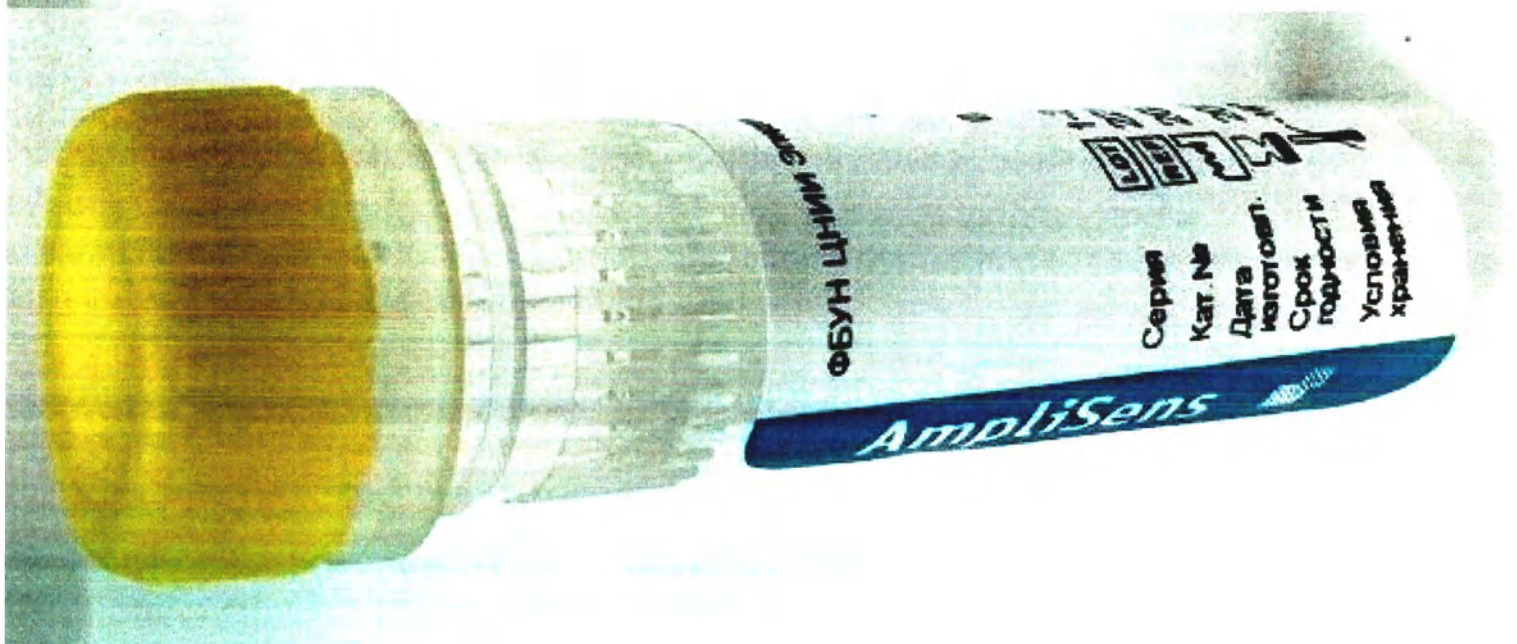
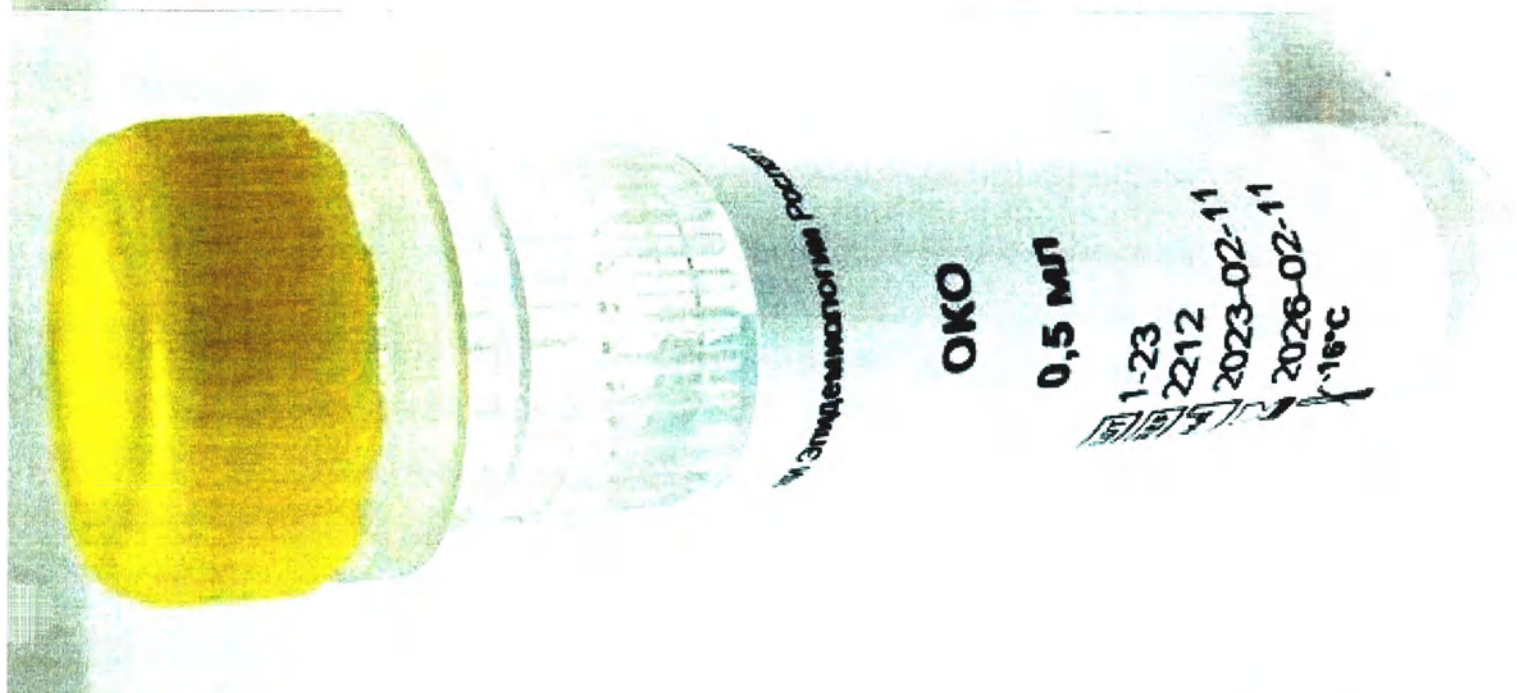
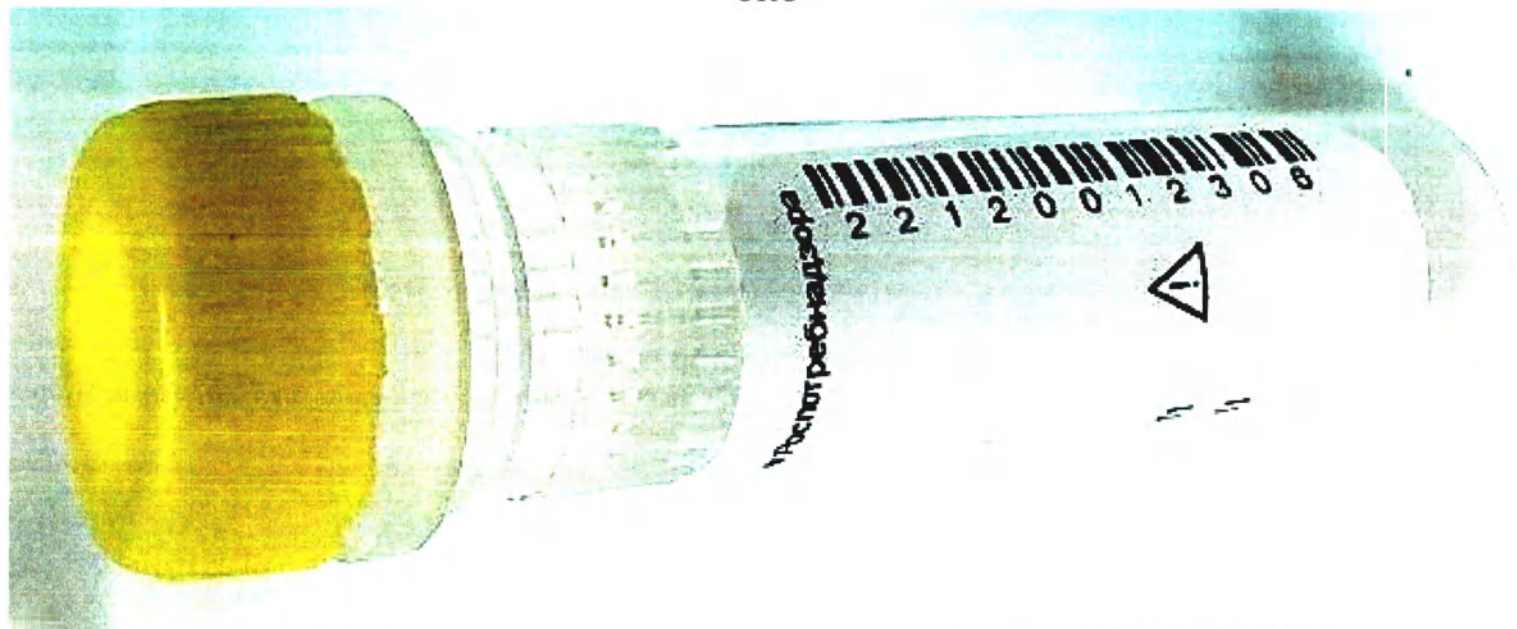




Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT
BKO STI-87-rec




Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

Буфер для элюции, ПКО кДНК HCV / HBV / HIV



Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT
Буфер для элюции



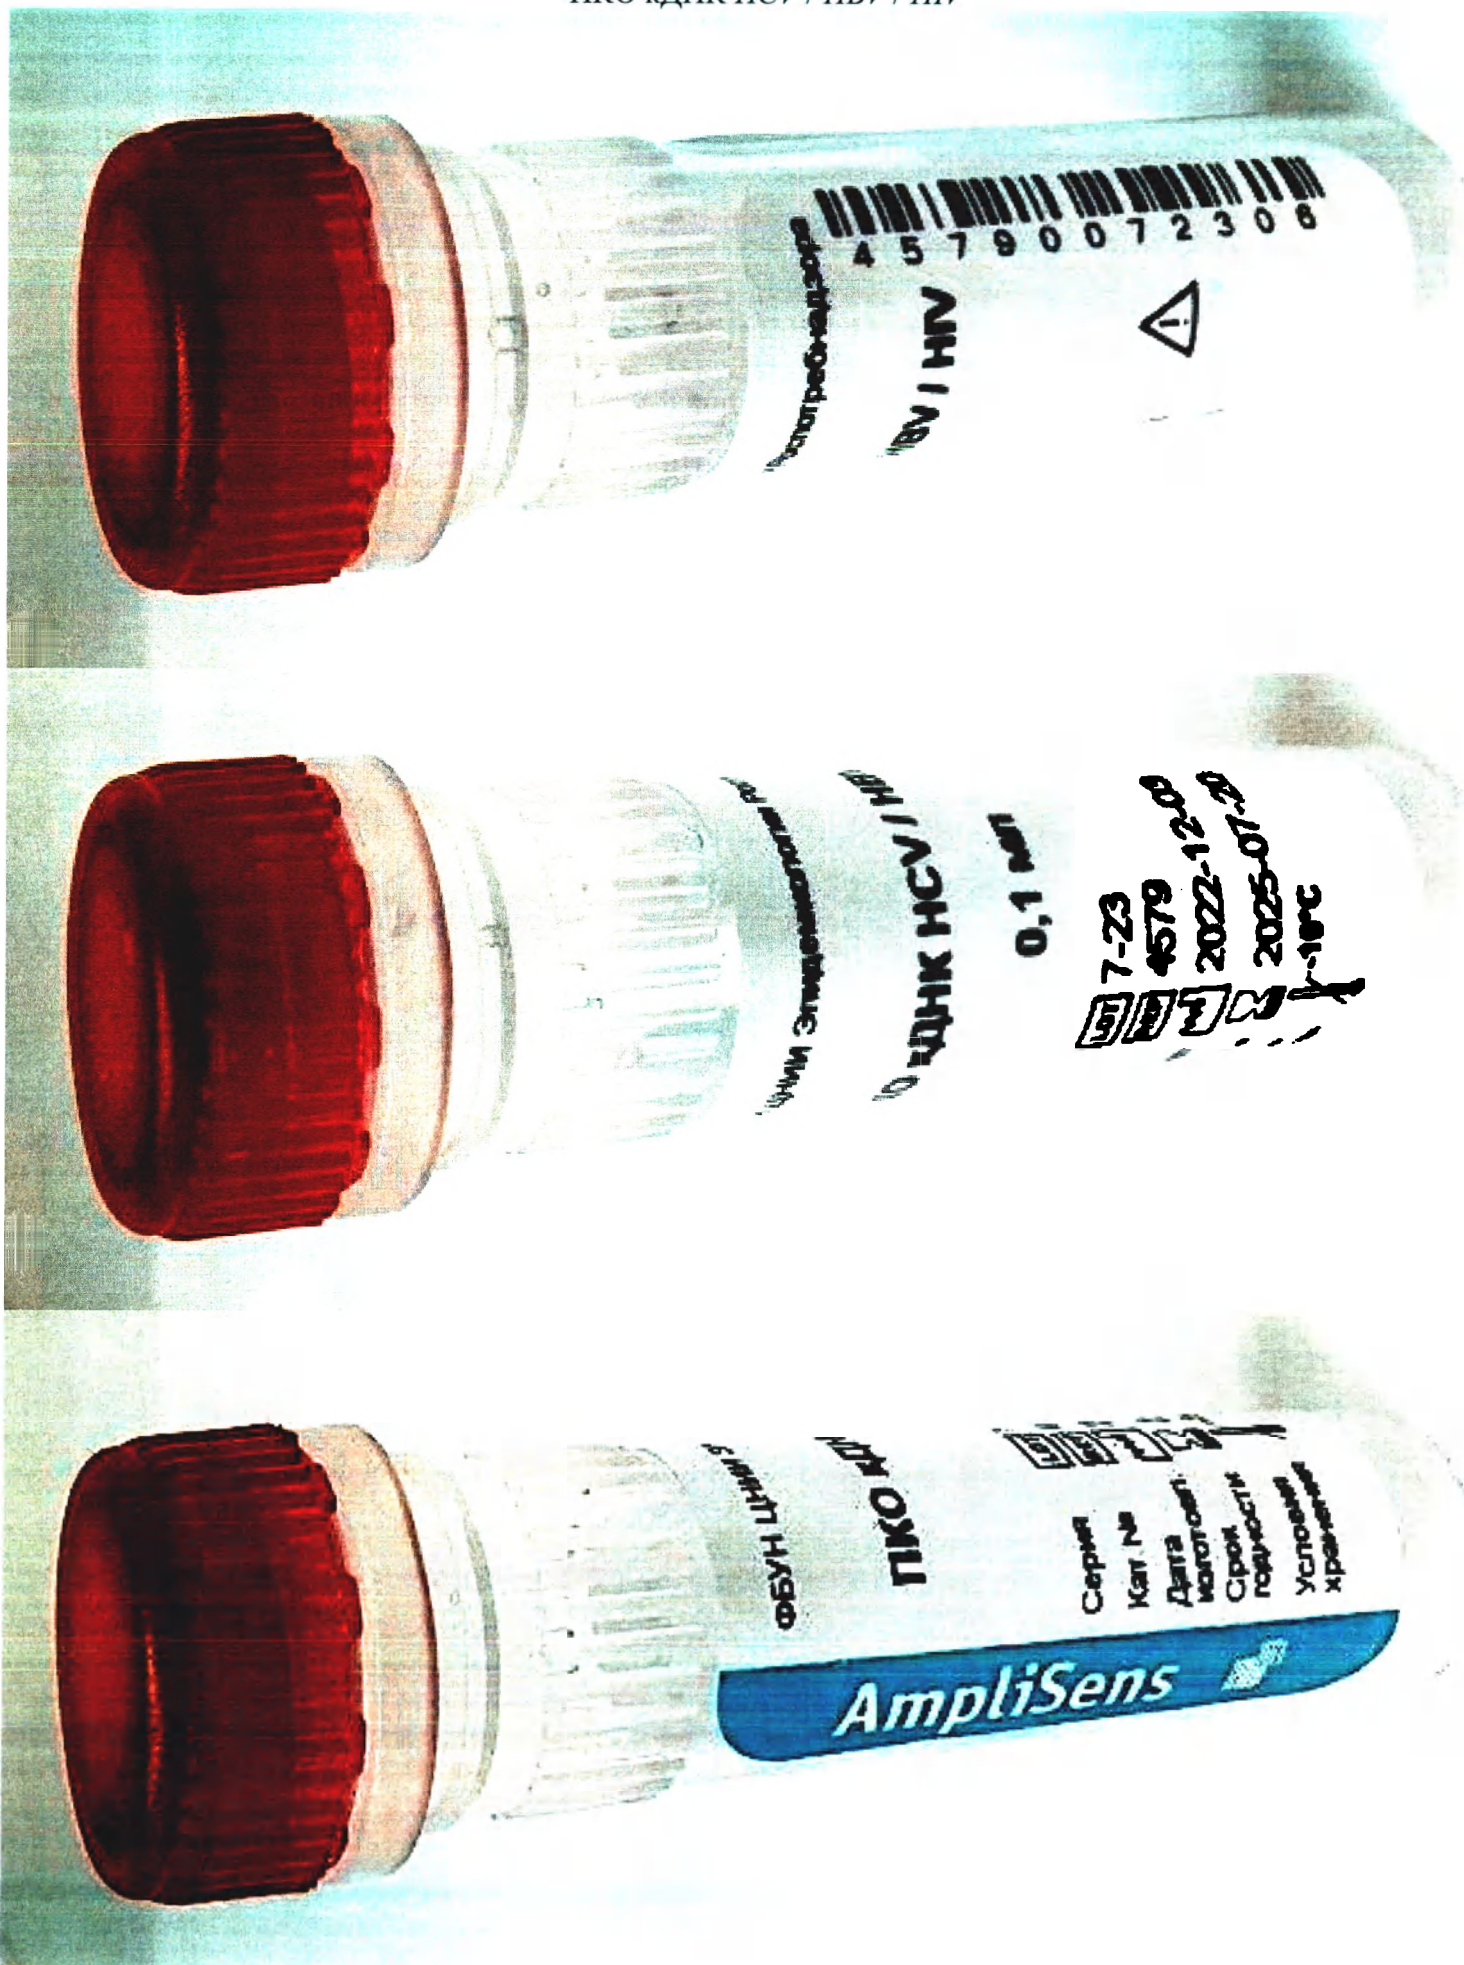



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новоогиревская, 1А
Москва, ул. Новоогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV),
ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита
человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Формы 1, 2


Программное обеспечение
AmpliSens® Немо-screen Soft 5х версия 1.0.1
Руководство оператора

REF HK3-3521-1

REF H-3522-1

ТУ 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер:

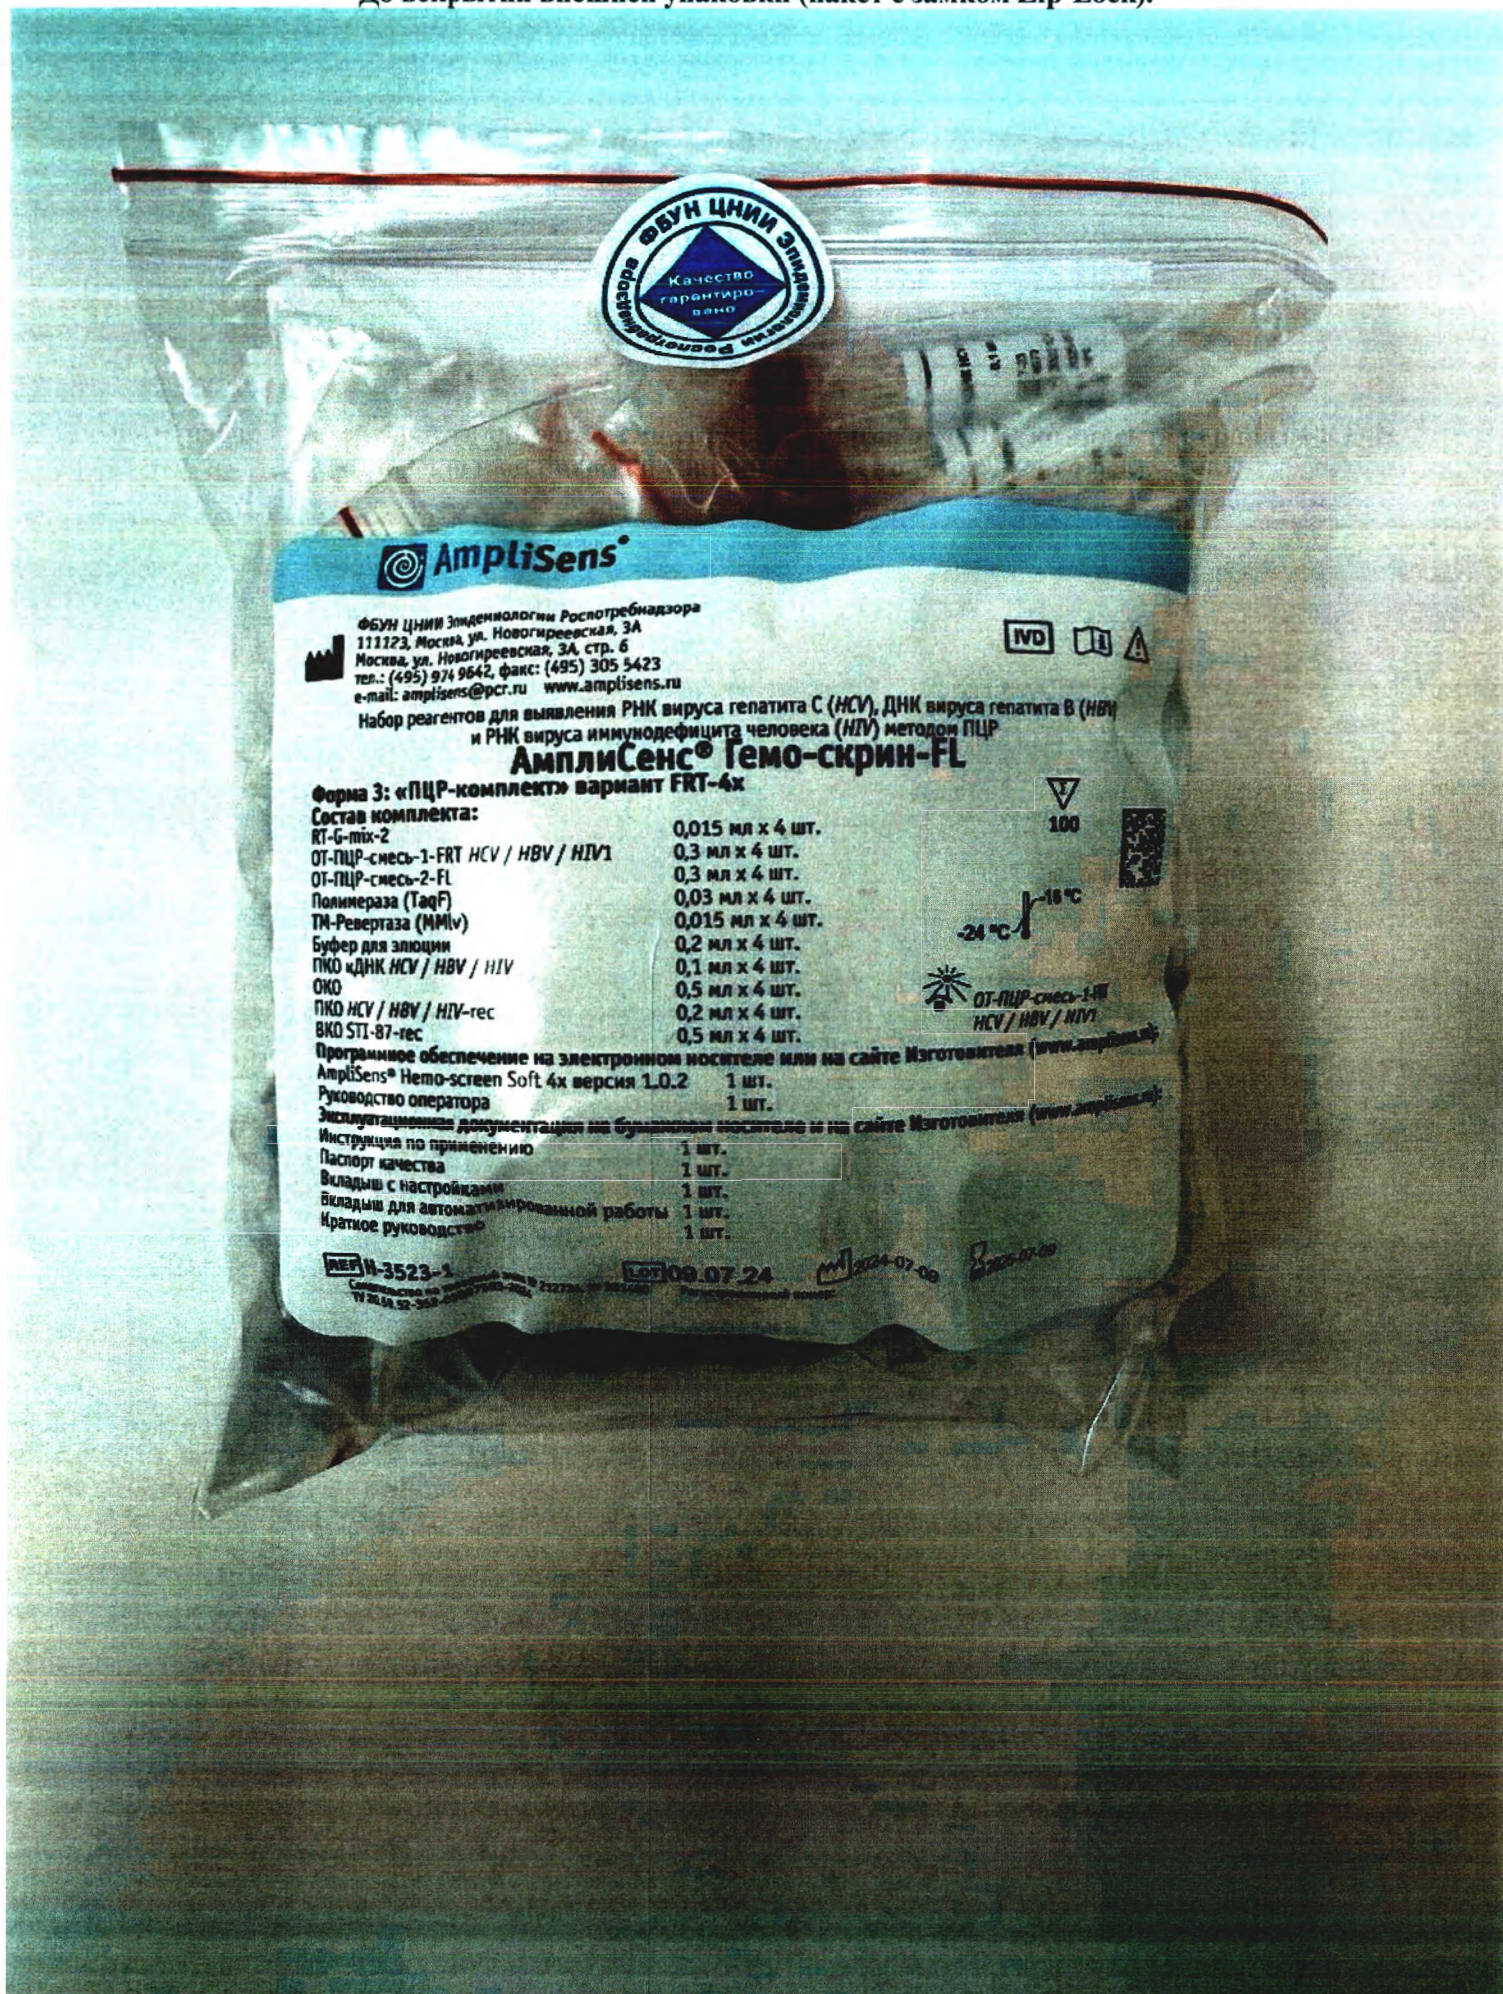

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1	0,3 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
TM-Рвертаза (MMiv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО «ДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-тес	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-тес	0,5 мл x 4 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru)
AmpliSens® Hemo-screen Soft 4x версия 1.0.2 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru)

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Выладыш с настройками 1 шт.

Выладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.

REF-3523-1


LOT 09.07.24


2024-07-09

Валерий

Свидетельство на товарный знак № 212726, № 261486

Регистрационный номер

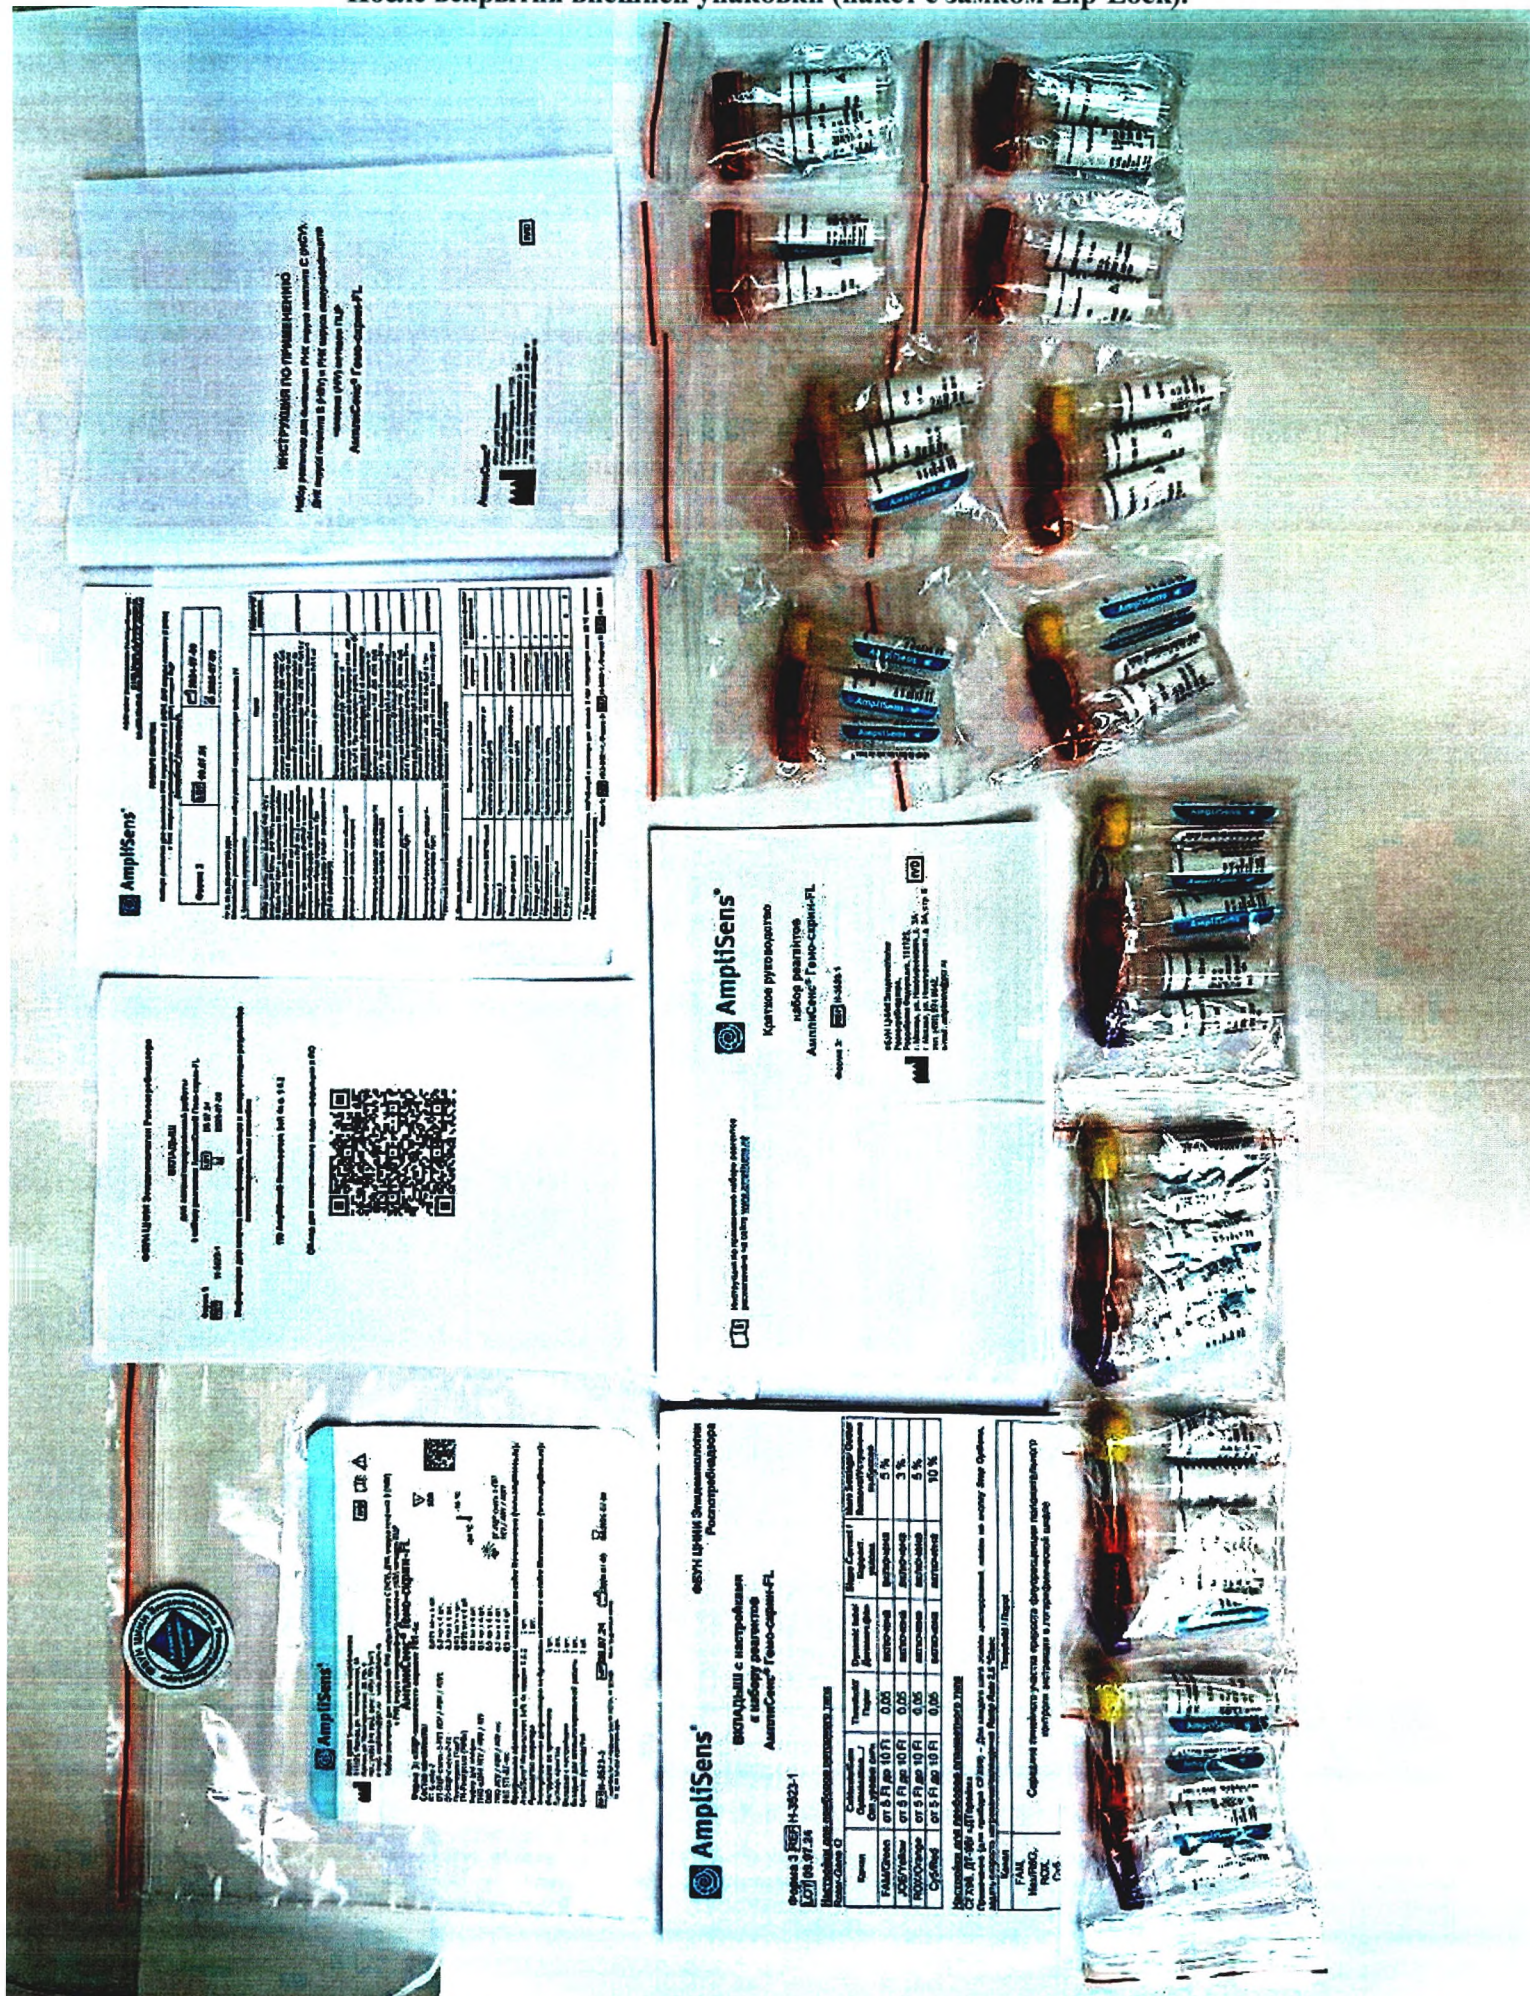

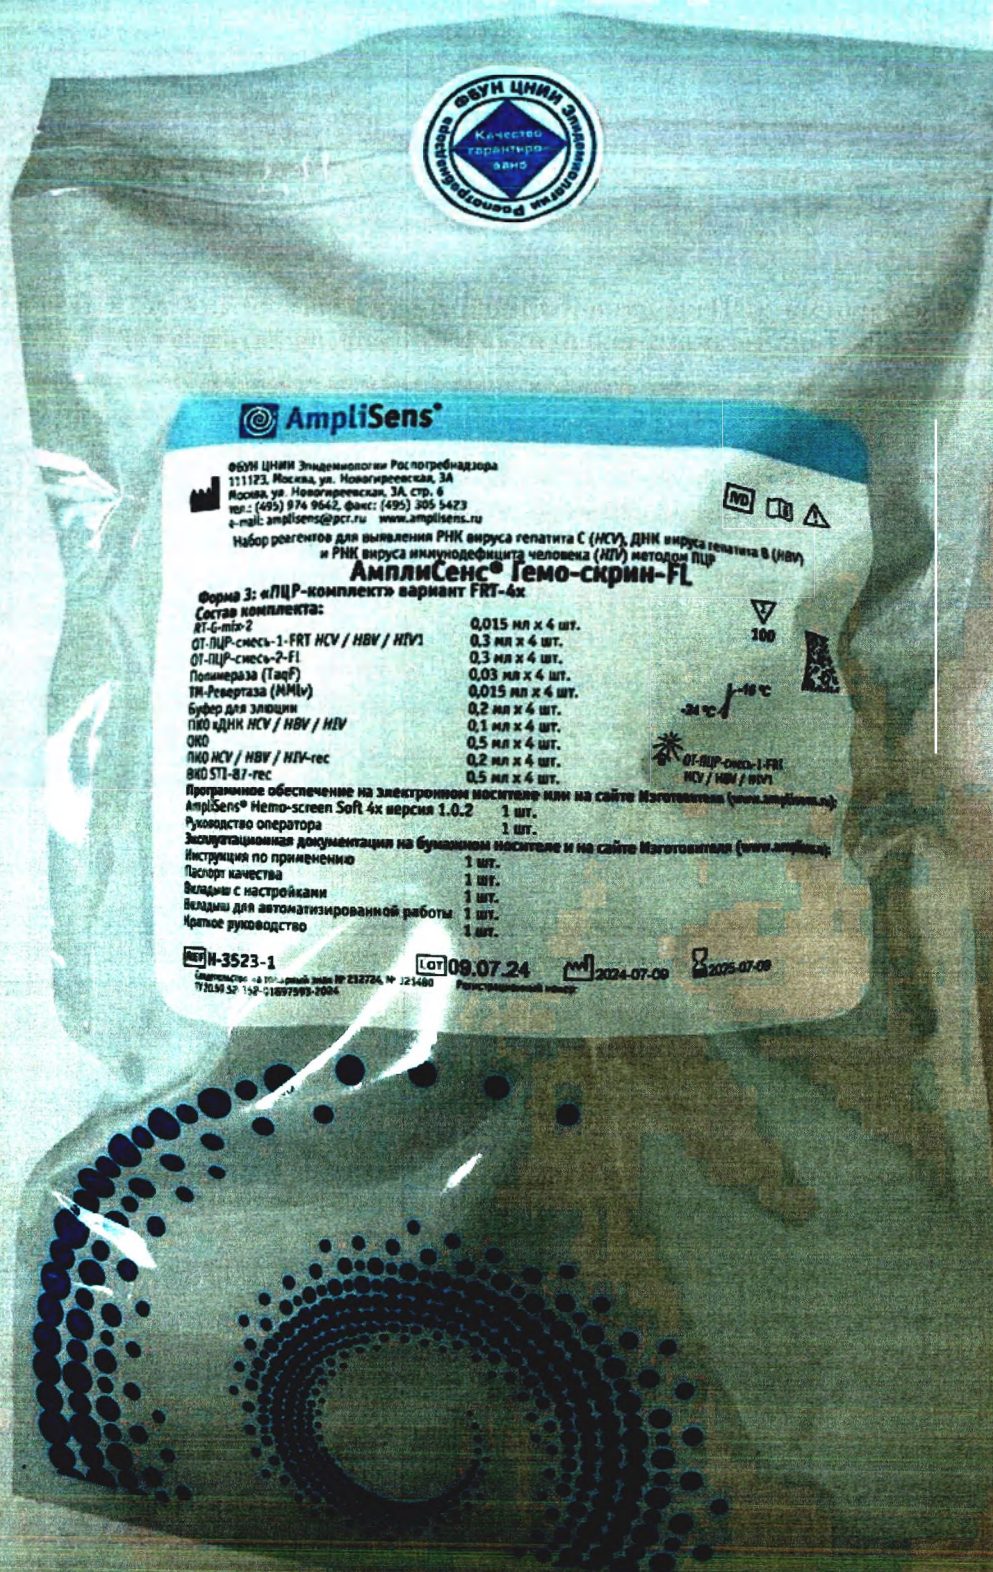

AmpliSens®

ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111173, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@rscg.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (НСV), ДНК вируса гепатита В (НВV)
и РНК вируса иммунодефицита человека (НIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х

Состав комплекта:

KT-6-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1	0,3 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-2-FRT	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
TM-Реввертаза (HIV-1)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элиции	0,2 мл x 4 шт.
ПВВ ДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
СВВ	0,5 мл x 4 шт.
ПВВ HCV / HBV / HIV-гес	0,2 мл x 4 шт.
ВВВ STI-81-гес	0,5 мл x 4 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru)

AmpliSens® Hemo-screen Soft 4x версия 1.0.2 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Защитная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru)

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Вкладыш с настройками 1 шт.

Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.

ИЗН-3523-1

Сертификат: «А» от 10-го июля 2024 № 232724 № 121480

LOT 09.07.24

2024-07-09

2025-07-09

712030 52 152-018073993-2004

Регистрационный номер:



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (НСV), ДНК вируса гепатита В (HBV)
и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1	0,3 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
ТМ-Реввертаза (MMiv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО «ДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-8 / -rec	0,5 мл x 4 шт.

100



-24 °C -16 °C



ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT
HCV / HBV / HIV1

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

AmpliSens® Hemo-screen Soft 4x версия 1.0.2 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Вкладыш с настройками 1 шт.

Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.

REF H-3523-1

LOT A09.07.24


2024-07-09



2025-07-09

Сертификат на товарный знак № 212724, № 321490
ТУ 20.59.52-392-01897583-2024

Регистрационный номер:

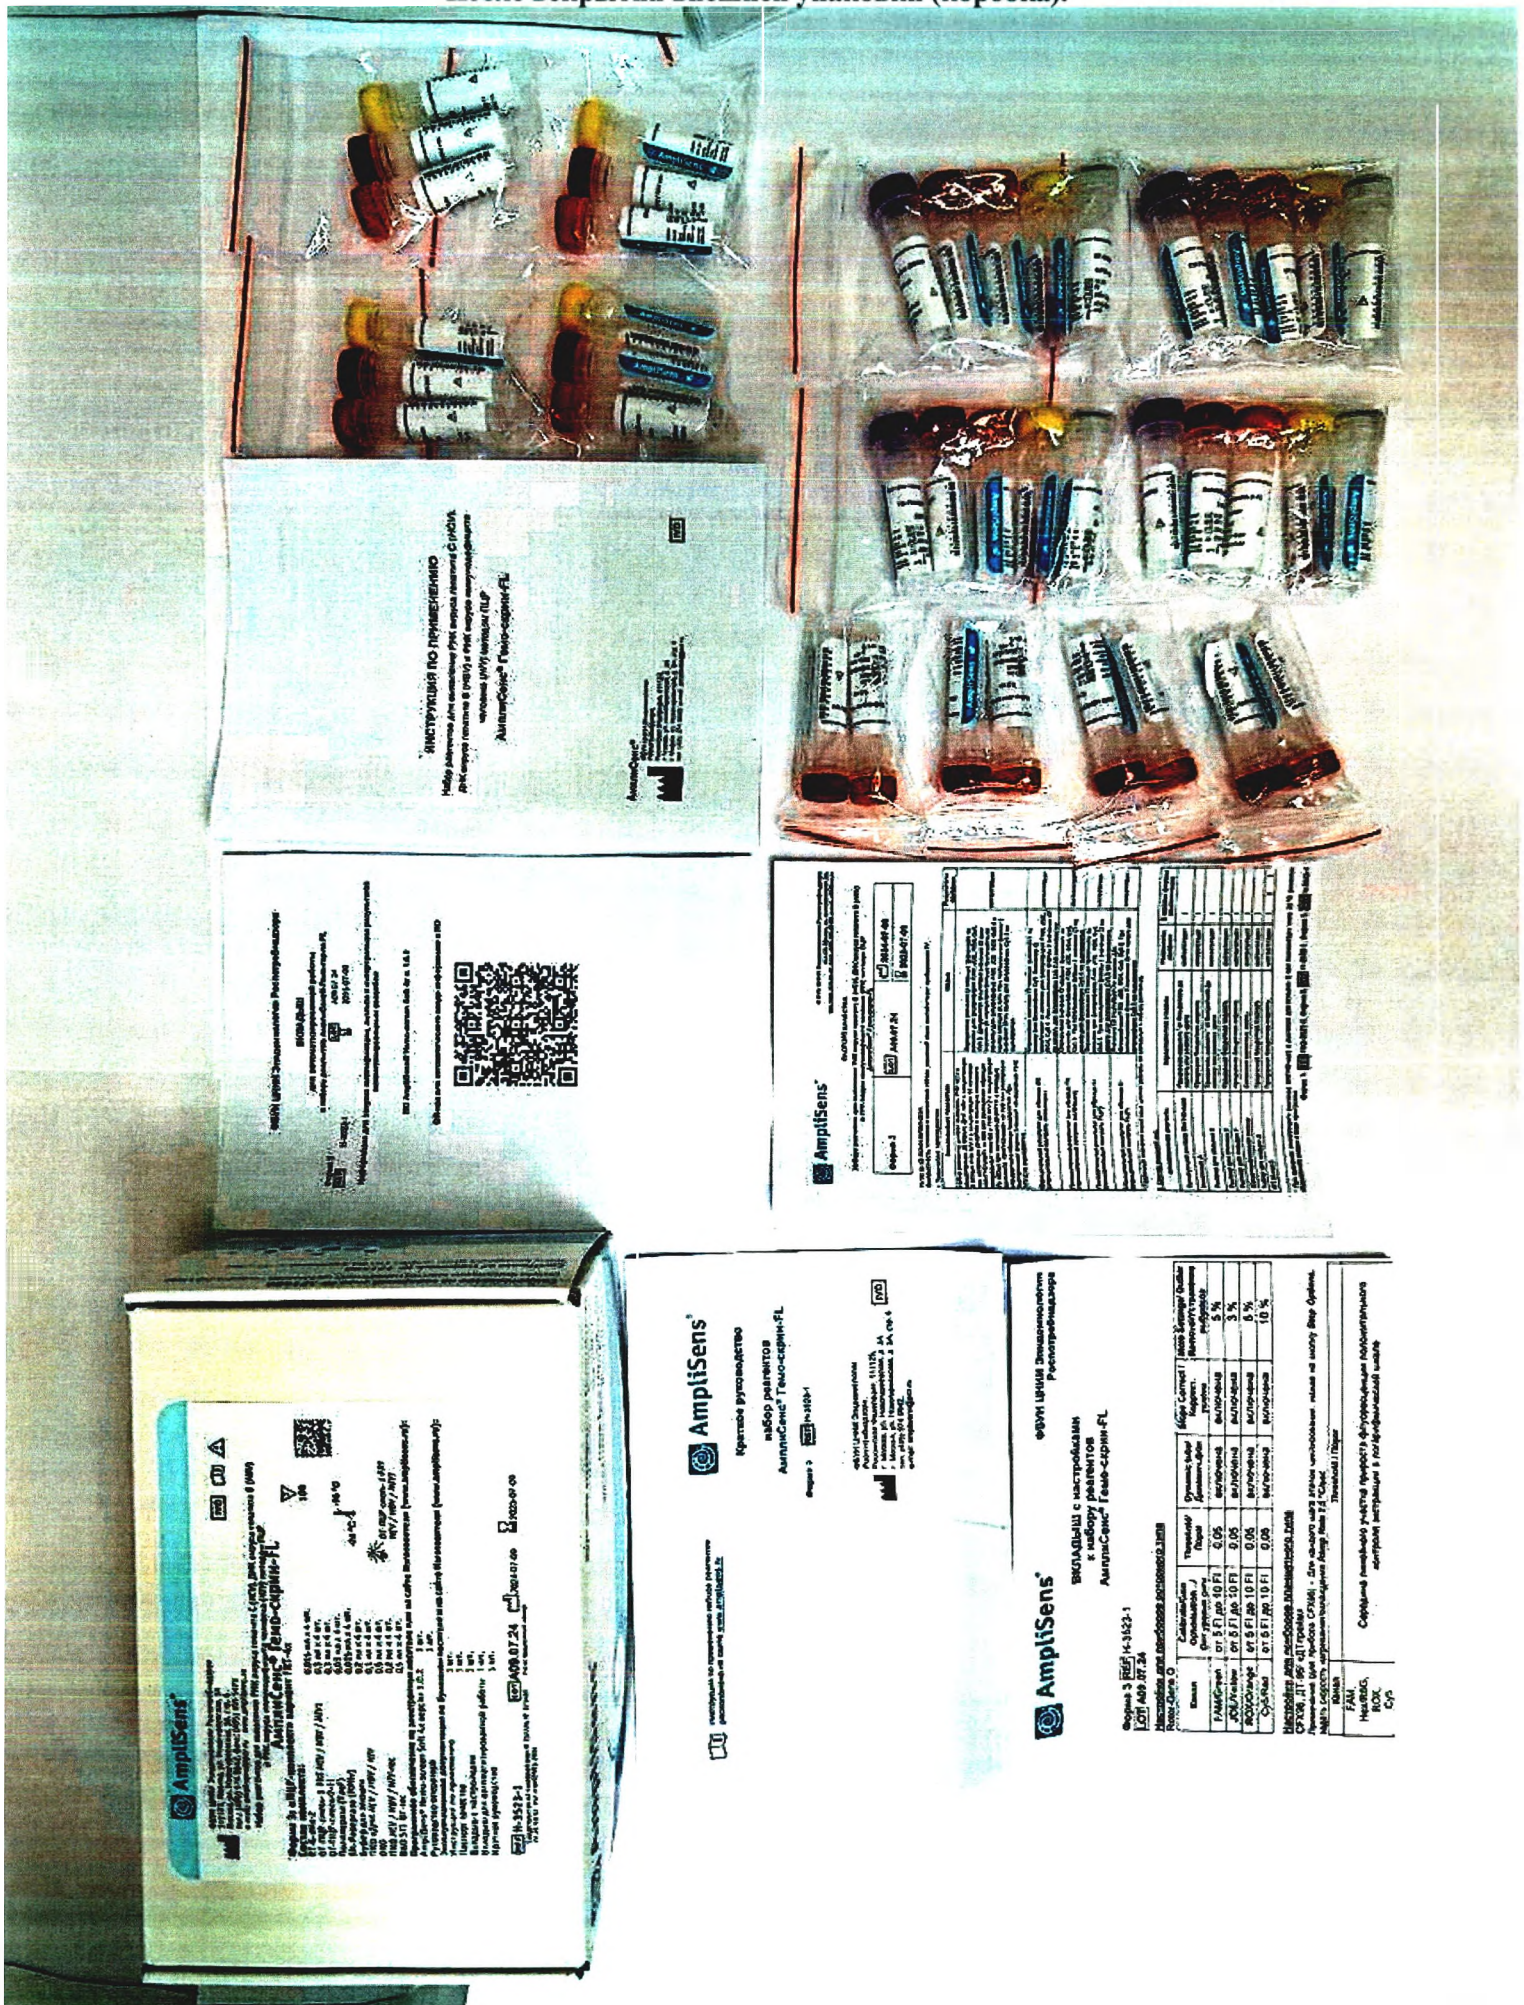

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для амплификации РНК вируса гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

ВНИМАНИЕ! Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

AmpliSens®
ВНИМАНИЕ! Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

AmpliSens®
ВНИМАНИЕ! Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

AmpliSens®
ВНИМАНИЕ! Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

AmpliSens®
ВНИМАНИЕ! Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
Реагенты предназначены для работы с вирусом гепатита С (HCV).
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Составляющие	Температура	Время	Объем
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл
AmpliSens®	95 °C	10 мин	100 мкл

Буфер для элюции, ПКО кДНК HCV / HBV / HIV

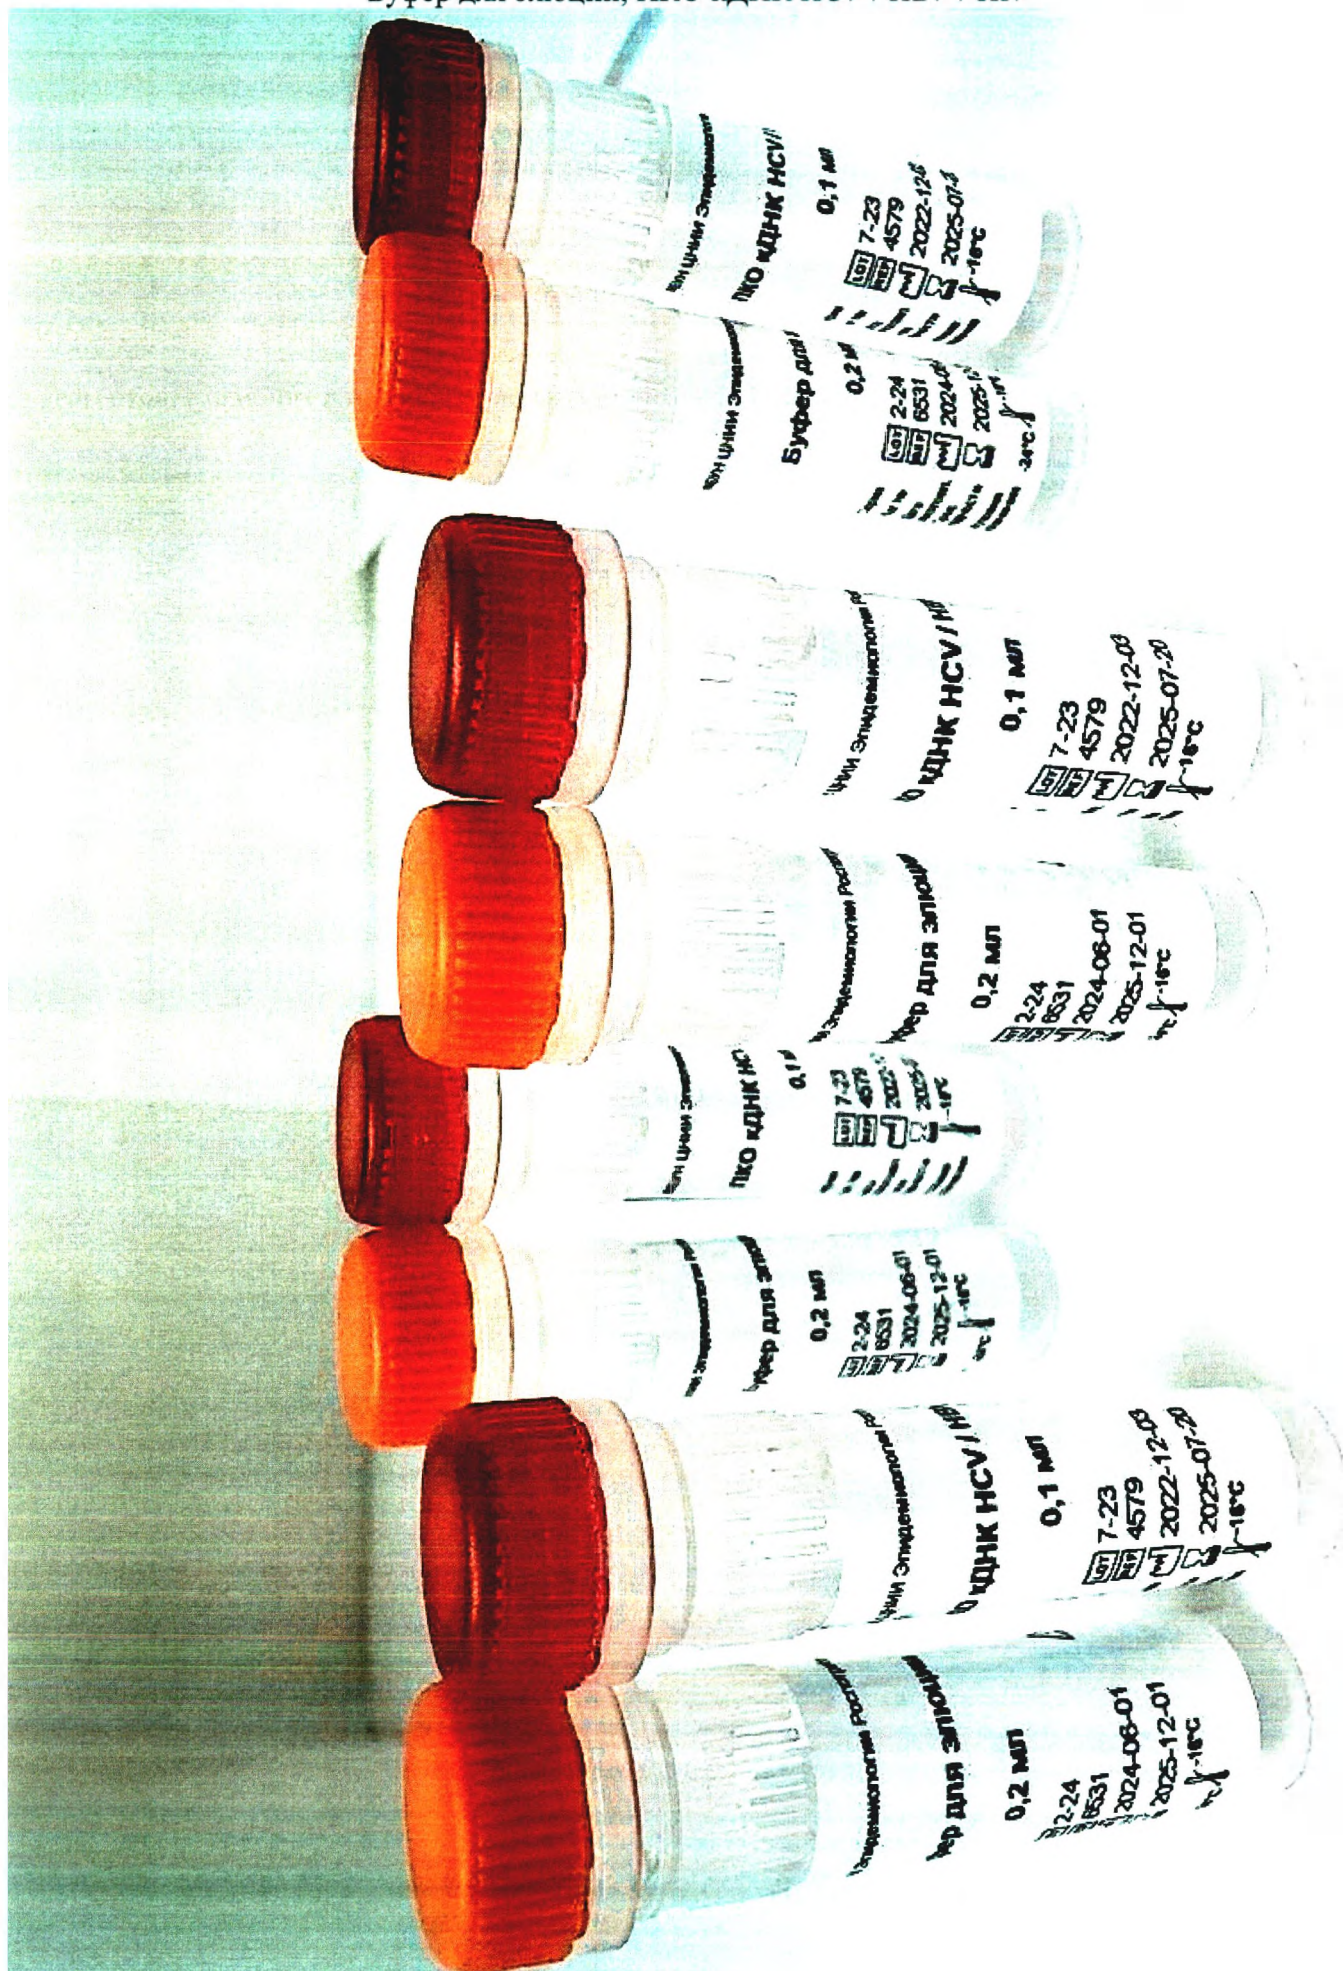


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х
Буфер для элюции

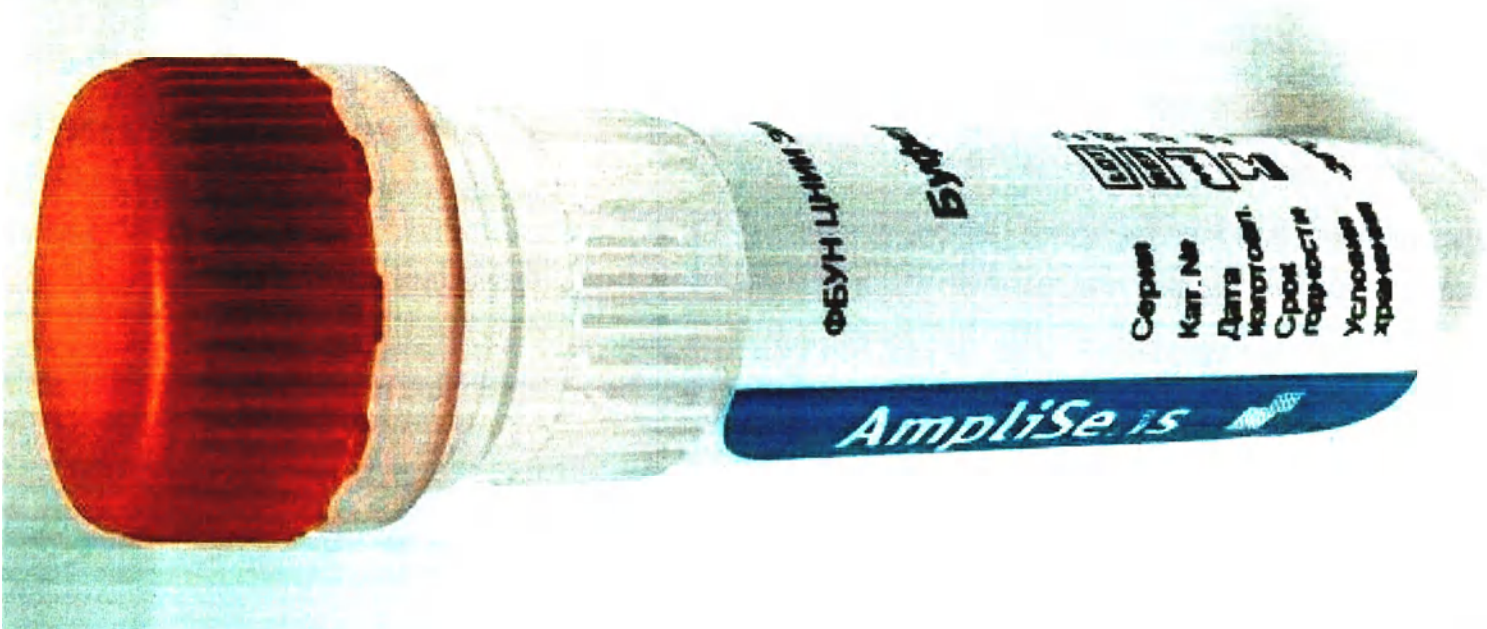
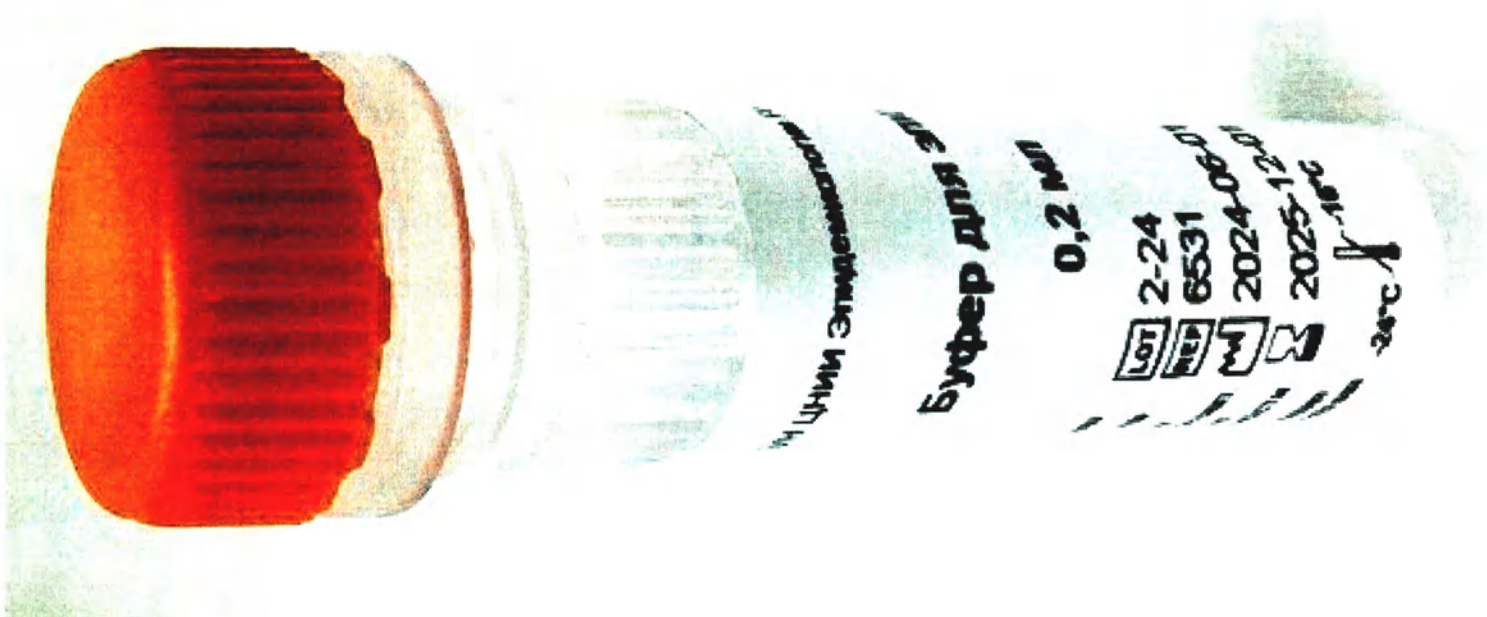












Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4x

RT-G-mix-2, ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV/ HBV/ HIV1, ОТ-ПЦР-смесь-2-FL, Полимераза (TaqF), ТМ-Ревертаза (MMIv)

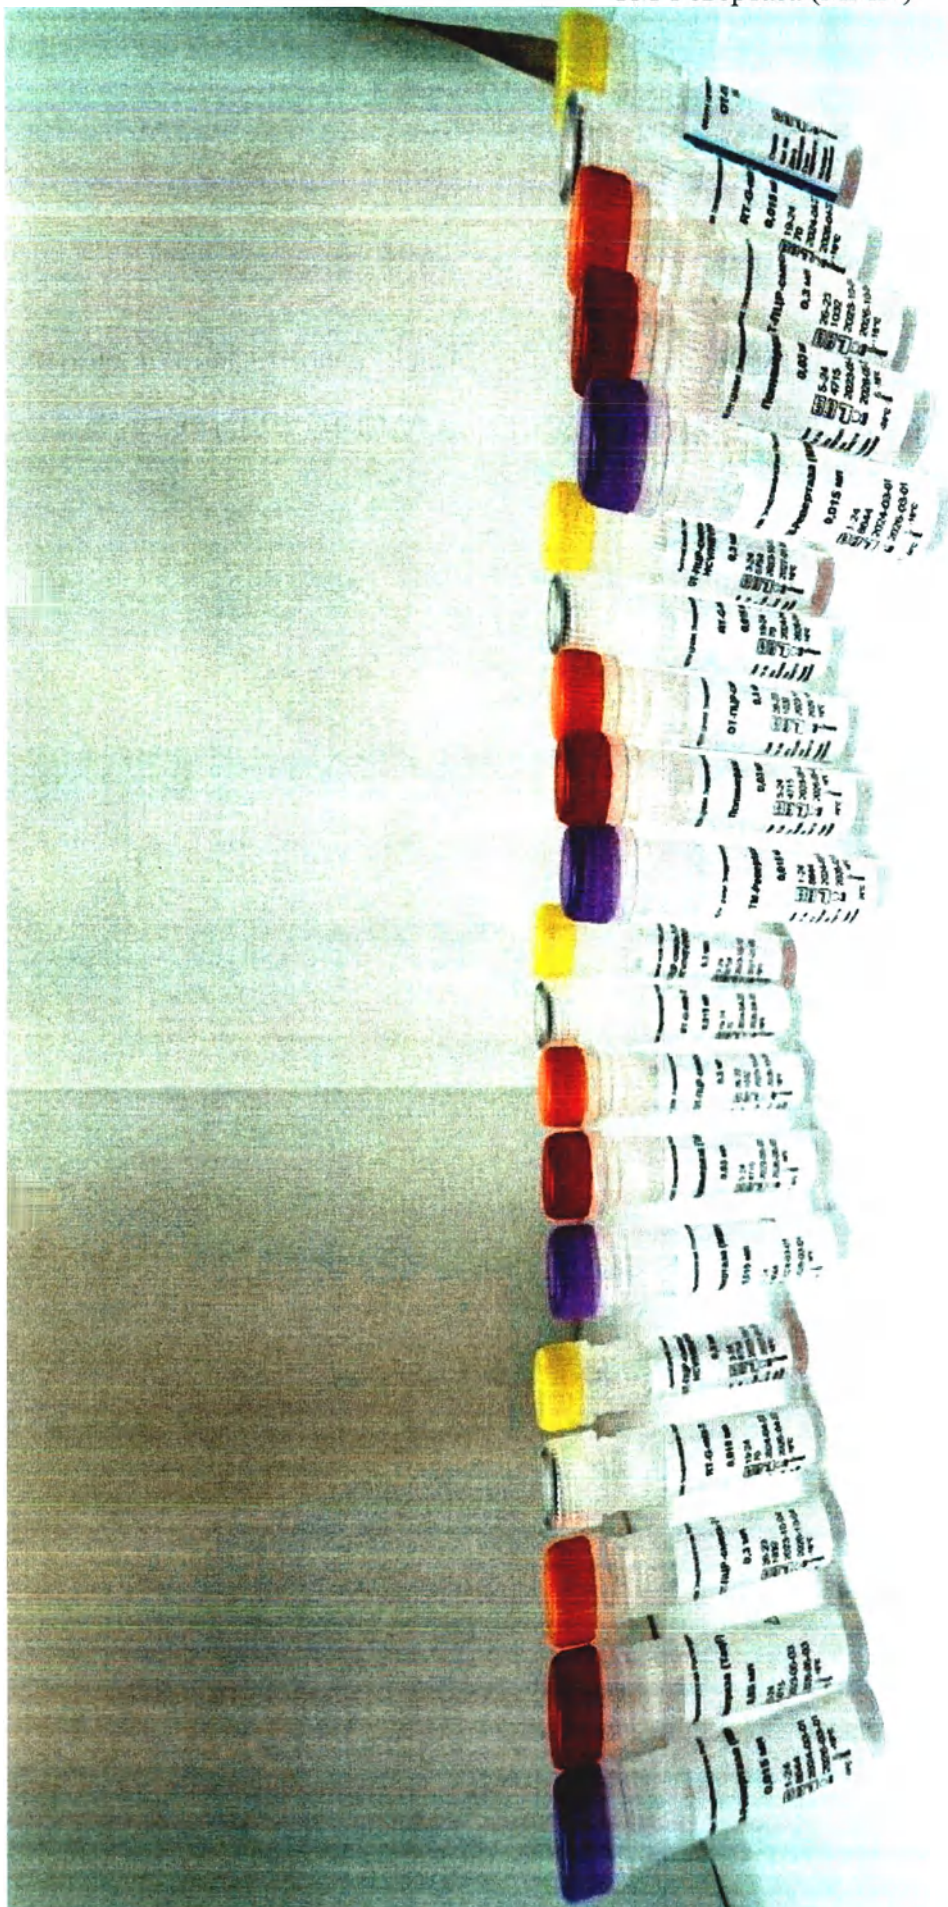


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х RT-G-mix-2





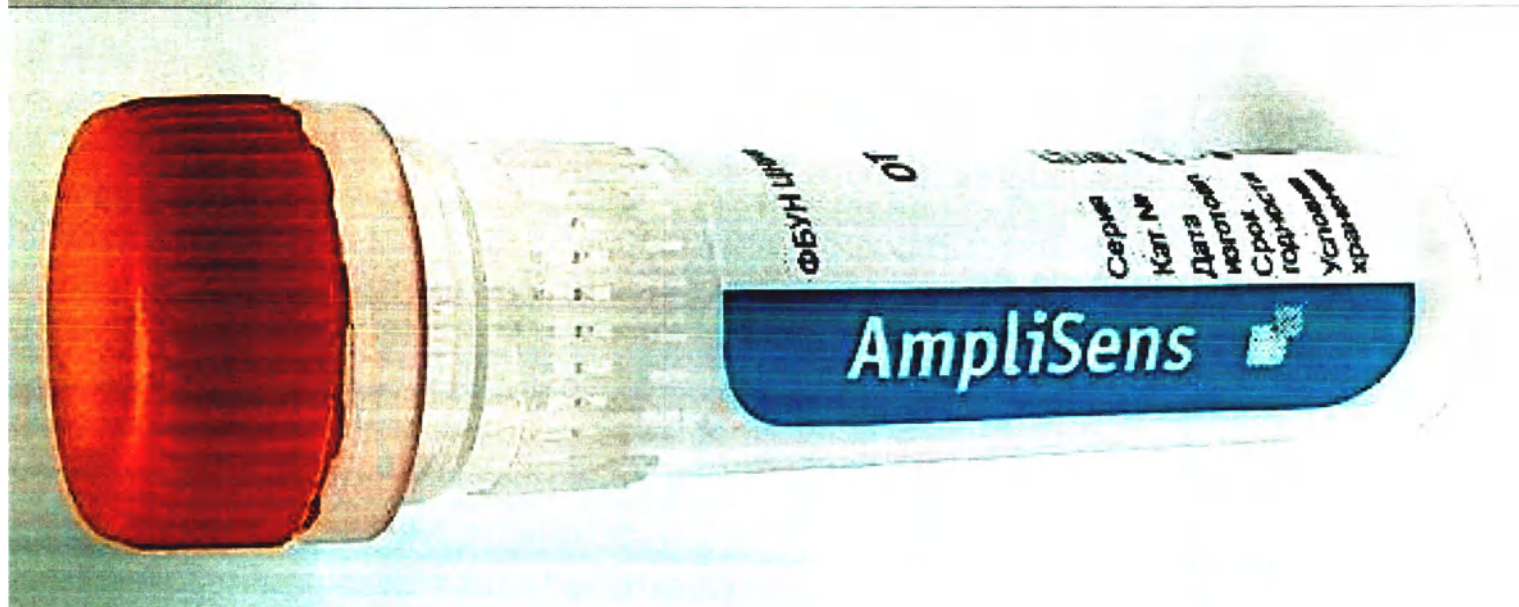
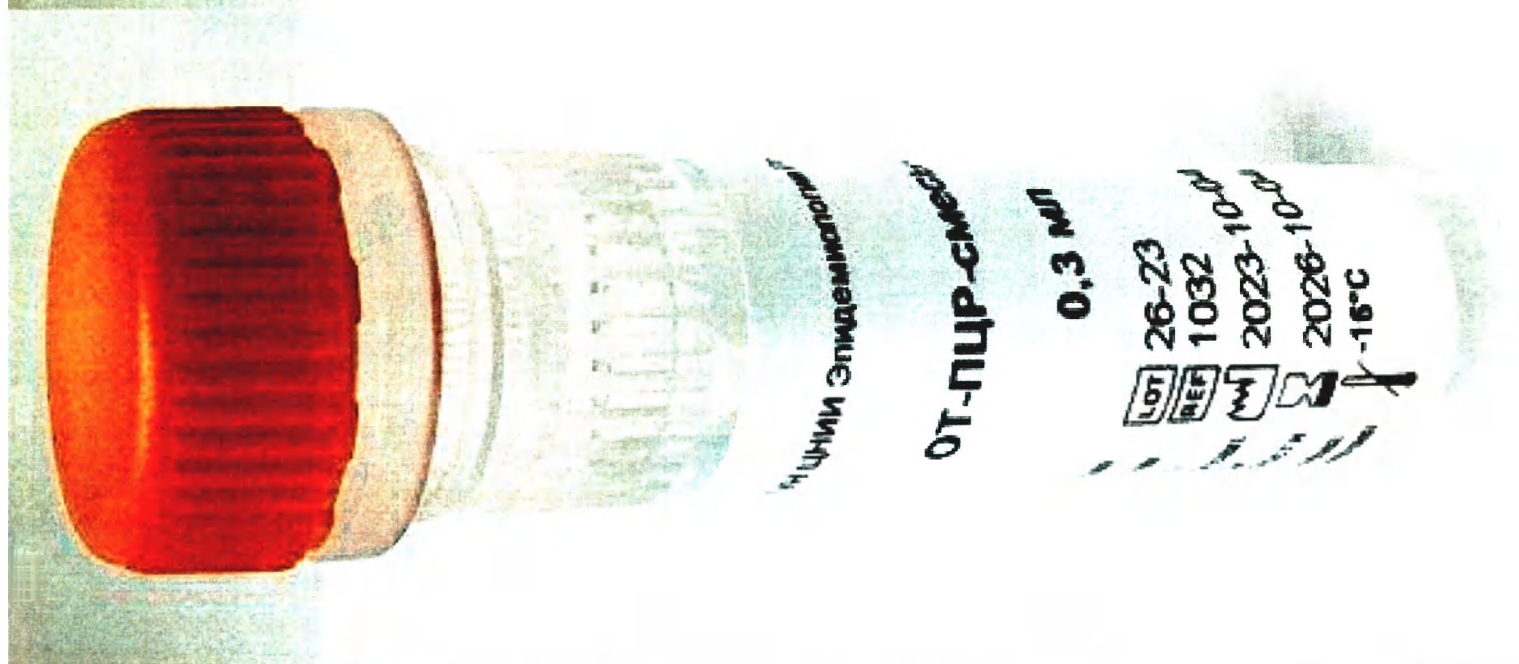
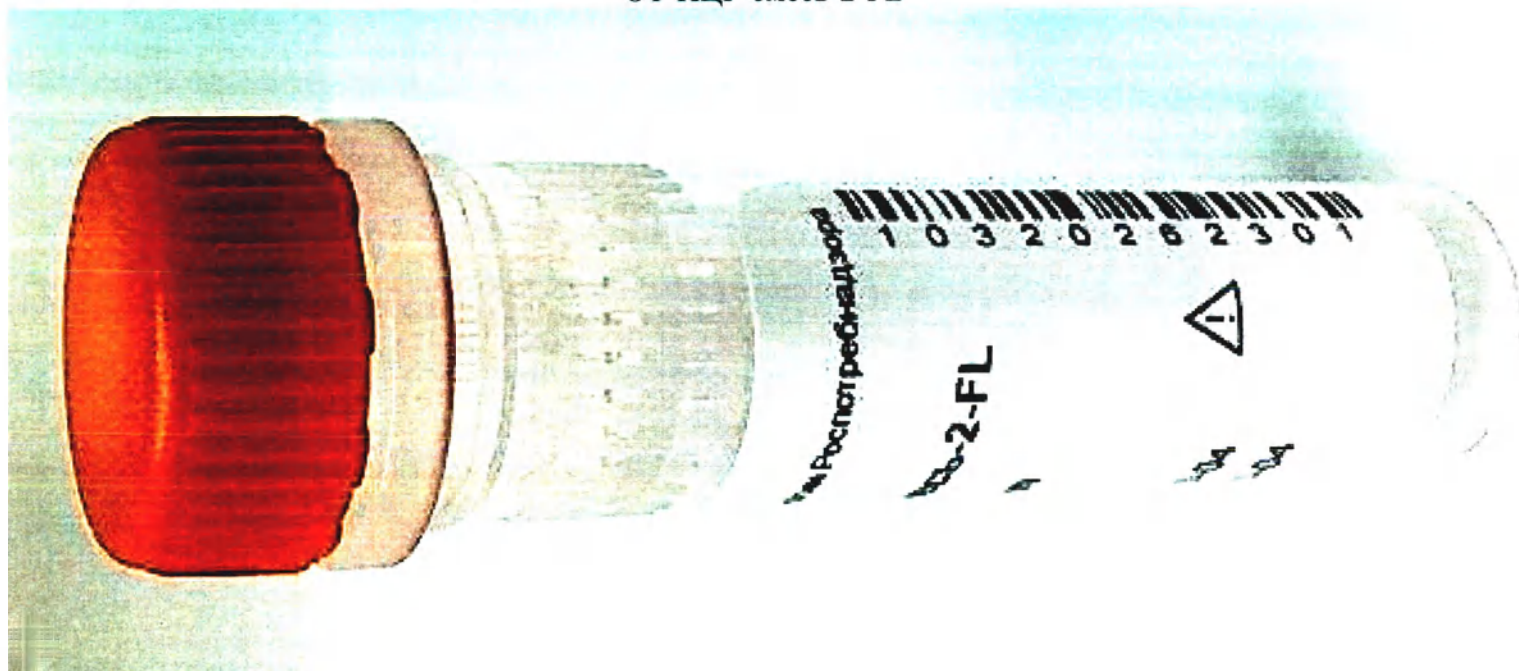


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х
 Полимераза (TaqF)


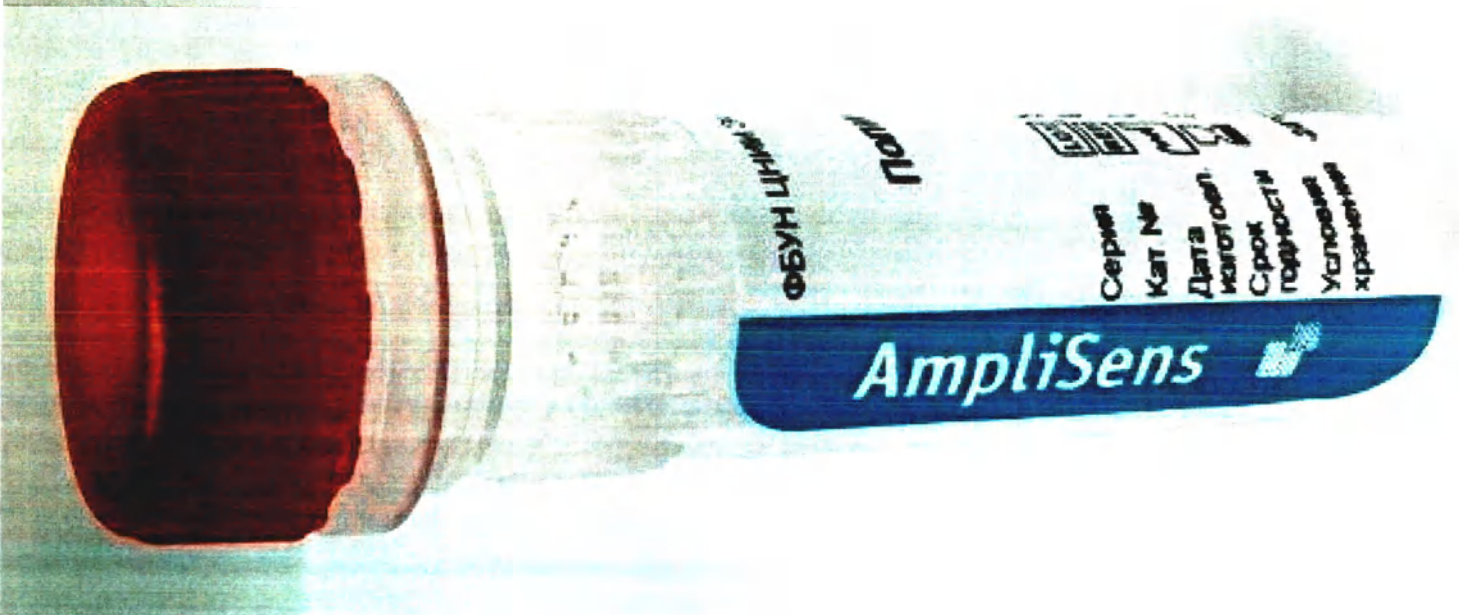


Фото реагентов, входящих в набор реагентов АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4х
ТМ-Ревертаза (MMIV)



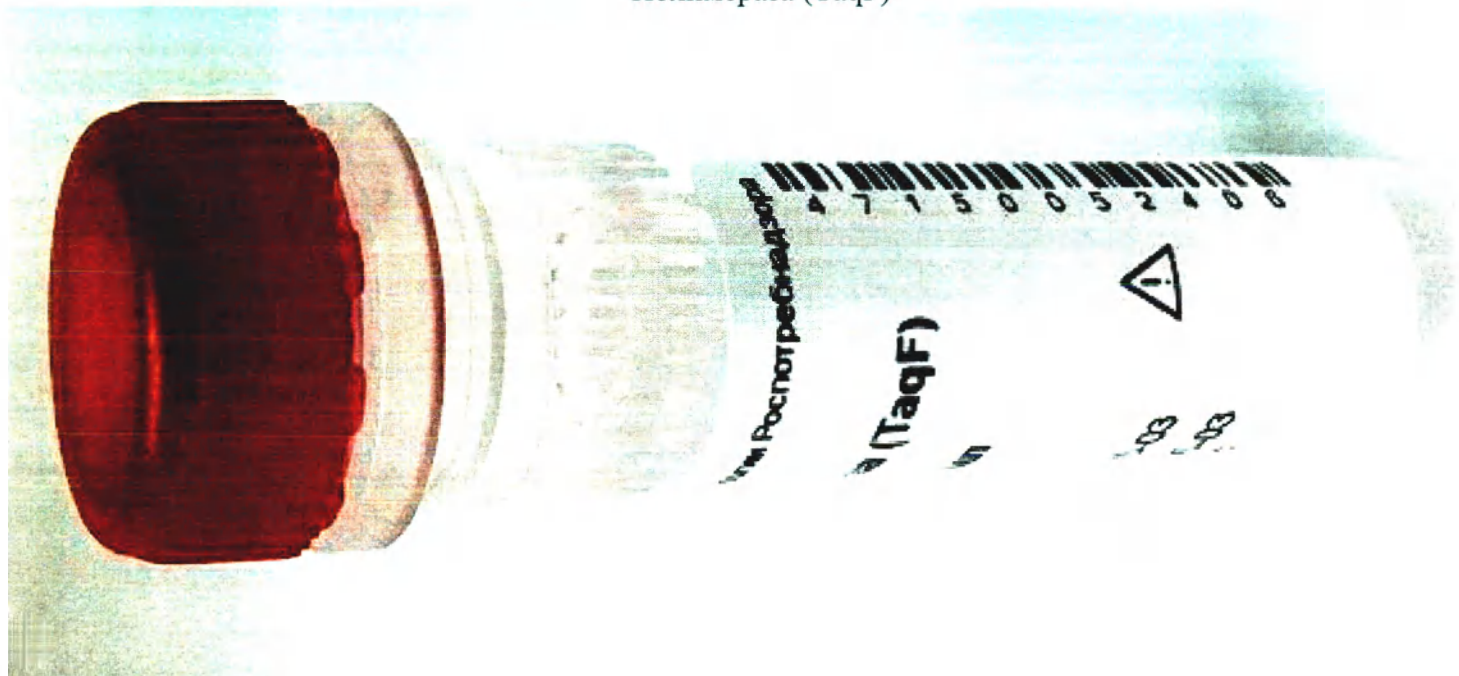

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогирьевская, 1А
Москва, ул. Новогирьевская, 1А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV),
ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита
человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3

Программное обеспечение
AmpliSens® Немо-screen Soft 4х версия 1.0.2
Руководство оператора

REF H-3523-1

ТУ 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер:

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 69

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

А.О.Лисицына

«08» ноября 2024 г.

М.П.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

В.Г. Акимкин

« 21 » октября 20 24 г.



Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT

На 6 листах

Маркировка комплекта «МАГНО-сорб» вариант 100-1000 (часть 1 из 2)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000; «ПЦР-комплект» вариант FRT
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	90 мл x 3 шт.
Компонент А	1,0 мл x 2 шт.
Раствор для отмывки 5	75 мл x 2 шт.
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1 шт.
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1 шт.
Магнетизированная силика	1,5 мл x 2 шт.
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

AmpliSens® Hemo-screen Soft 5x версия 1.0.1 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Вкладыш с настройками 1 шт.

Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.




Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-352-01897593-2024



Регистрационный номер:

2 °C 25 °C



Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «МАГНО-сорб» вариант 100-1000 (часть 1 из 2)

Наименование реагента

Маркировка


Лизирующий раствор МАГНО-сорб



Компонент А



Раствор для отмывки 5

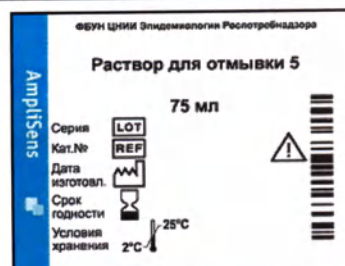


Раствор для отмывки 6	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 6 87 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C AmpliSens
Раствор для отмывки 7	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Раствор для отмывки 7 35 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C AmpliSens
Магнетизированная силика	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Магнетизированная силика 1,5 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C AmpliSens
Буфер для элюции А	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Буфер для элюции А 1,25 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изготовл. Срок годности Условия хранения 2°C AmpliSens

Маркировка комплекта «ПЦР-комплект» вариант FRT (часть 2 из 2)



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000;
«ПЦР-комплект» вариант FRT

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

«ПЦР-комплект» вариант FRT

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2	0,3 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
ТМ-Ревертаза (MMIv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-rec	0,5 мл x 4 шт.

100



-24 °C -16 °C



ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT
HCV / HBV / HIV1 / HIV2



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-352-01897593-2024

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «ПЦР-комплект» вариант FRT (часть 2 из 2)

Наименование реагента	Маркировка
RT-G-mix-2	
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV/HBV/HIV1/HIV2	
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	

Полимераза (TaqF)	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полимераза (TaqF) 0,03 мл Серия: LOT Кат. №: REF Дата изготовления: MM Срок годности: Условия хранения: -24°C -16°C Amplisens
TM-Реввертаза (MMIv)	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора TM-Реввертаза (MMIv) 0,015 мл Серия: LOT Кат. №: REF Дата изготовления: MM Срок годности: Условия хранения: -24°C -16°C Amplisens
Буфер для элюции	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Буфер для элюции 0,2 мл Серия: LOT Кат. №: REF Дата изготовления: MM Срок годности: Условия хранения: -24°C -16°C Amplisens
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ПКО кДНК HCV / HBV / HIV 0,1 мл Серия: LOT Кат. №: REF Дата изготовления: MM Срок годности: Условия хранения: -16°C Amplisens
ОКО	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора ОКО 0,5 мл Серия: LOT Кат. №: REF Дата изготовления: MM Срок годности: Условия хранения: -16°C Amplisens

ПКО HCV / HBV / HIV-rec	
ВКО STI-87-rec	

Маркировка программного обеспечения
 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Формы 1, 2 Программное обеспечение AmpliSens® Hemo-screen Soft 5x версия 1.0.1 Руководство оператора   ТУ 20.59.52-352-01897593-2024 Регистрационный номер:

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Программное обеспечение маркируется в случае поставки на цифровом носителе.

цель

ЛИСТ 06

(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

« 08 » ноября 20 24 г.

М.П.




«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

В.Г. Акимкин

«21» октября 2024 г.

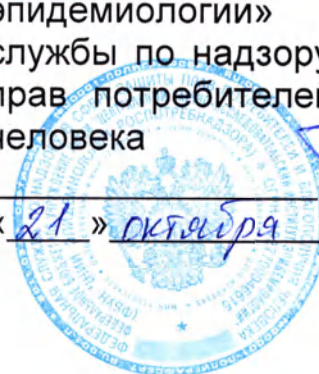

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК
вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека
(HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

На 4 листах

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974-9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Темо-скрин-FL

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1 / HIV2	0,3 мл x 4 шт.
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
ТМ-Реввертаза (MMiv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-rec	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-rec	0,5 мл x 4 шт.

Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):
AmpliSens® Hemo-screen Soft 5x версия 1.0.1 1 шт.
Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):
Инструкция по применению 1 шт.
Паспорт качества 1 шт.
Вкладыш с настройками 1 шт.
Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.
Краткое руководство 1 шт.


100
-24 °C -16 °C

ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT
HCV / HBV / HIV1 / HIV2

 Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.59.52-352-01.897/593-2024

 Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «ПЦР-комплект» вариант FRT

Наименование реагента	Маркировка
RT-G-mix-2	
ОТ-ПЦР-смесь-1-FRT HCV/HBV/HIV1/HIV2	
ОТ-ПЦР-смесь-2-FL	

Полимераза (TaqF)	 AmpliSens
TM-Реввертаза (MMiv)	 AmpliSens
Буфер для элюции	 AmpliSens
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	 AmpliSens
ОКО	 AmpliSens

ПКО HCV / HBV / HIV-rec	
ВКО STI-87-rec	

Маркировка программного обеспечения
 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@rct.ru www.amplisens.ru Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР АмплиСенс® Гемо-скрин-FL Формы 1, 2 Программное обеспечение AmpliSens® Hemo-screen Soft 5x версия 1.0.1 Руководство оператора   ТУ 20.59.52-352-01897593-2024 Регистрационный номер:

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Программное обеспечение маркируется в случае поставки на цифровом носителе.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 4
четыре лист а

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

А.О.Лисицына



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

В.Г. Акимкин

« 21 » октября 20 24 г.

Макет маркировки медицинского изделия

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК
вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека
(HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4x

На 4 листах

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-4x



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru




Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР

АмплиСенс® Гемо-скрин-FL

Форма 3: «ПЦР-комплект» вариант FRT-4x

Состав комплекта:

RT-G-mix-2	0,015 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-1-FRT HCV / HBV / HIV1	0,3 мл x 4 шт.
OT-ПЦР-смесь-2-FL	0,3 мл x 4 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 4 шт.
TM-Реввертаза (MMIv)	0,015 мл x 4 шт.
Буфер для элюции	0,2 мл x 4 шт.
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	0,1 мл x 4 шт.
ОКО	0,5 мл x 4 шт.
ПКО HCV / HBV / HIV-tes	0,2 мл x 4 шт.
ВКО STI-87-tes	0,5 мл x 4 шт.



Программное обеспечение на электронном носителе или на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

AmpliSens® Hemo-screen Soft 4x версия 1.0.2 1 шт.

Руководство оператора 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте Изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества 1 шт.

Вкладыш с настройками 1 шт.

Вкладыш для автоматизированной работы 1 шт.

Краткое руководство 1 шт.



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 20.50.52-352-01897593-2024



Регистрационный номер:



Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта «ПЦР-комплект» вариант FRT-4x

Наименование реагента	Маркировка
RT-G-mix-2	
OT-ПЦР-смесь-1-FRT HCV/HBV/HIV1	
OT-ПЦР-смесь-2-FL	

Полимераза (TaqF)	
TM-Ревертаза (MMIv)	
Буфер для элюции	
ПКО кДНК HCV / HBV / HIV	
ОКО	

ПКО HCV / HBV / HIV-rec	
ВКО STI-87-rec	

Маркировка программного обеспечения	
	
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423 e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru	
Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита В (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека (HIV) методом ПЦР	
АмплиСенс® Гемо-скрин-FL	
Форма 3	
Программное обеспечение AmpliSens® Hemo-screen Soft 4x версия 1.0.2	
Руководство оператора	
REF	
ТУ 20.59.52-352-01897593-2024 Регистрационный номер:	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Программное обеспечение маркируется в случае поставки на цифровом носителе.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 4
четыре лист 2

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

А.О.Лисицына

«08» ноября 2024 г.

М.П.

