

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «ИМПЛАНТ ТРЕЙД»

Терентьев К.М.

«16» октября 2023 г.
М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия

Система дентальных имплантатов

2023 г.

Система дентальных имплантатов (финальная транспортная упаковка)



Система дентальных имплантатов (малая транспортная упаковка)



I. Имплантаты дентальные (Dental Implants):

Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)
(потребительская упаковка)



Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)
(потребительская упаковка – оборотная сторона)



Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)
Макет маркировки на русском языке

Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)

РУ № xxxxx от дд. мм. гггг.


Производитель: МегаДжен Имплант Ко., Лтд, 45 Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu 42921, Korea

Уполномоченный представитель в России:


ООО «ИМПЛАНТ ТРЕЙД», 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7.

Осторожно! Перед использованием, обратитесь к инструкции по применению.

Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)
(индивидуальная упаковка)

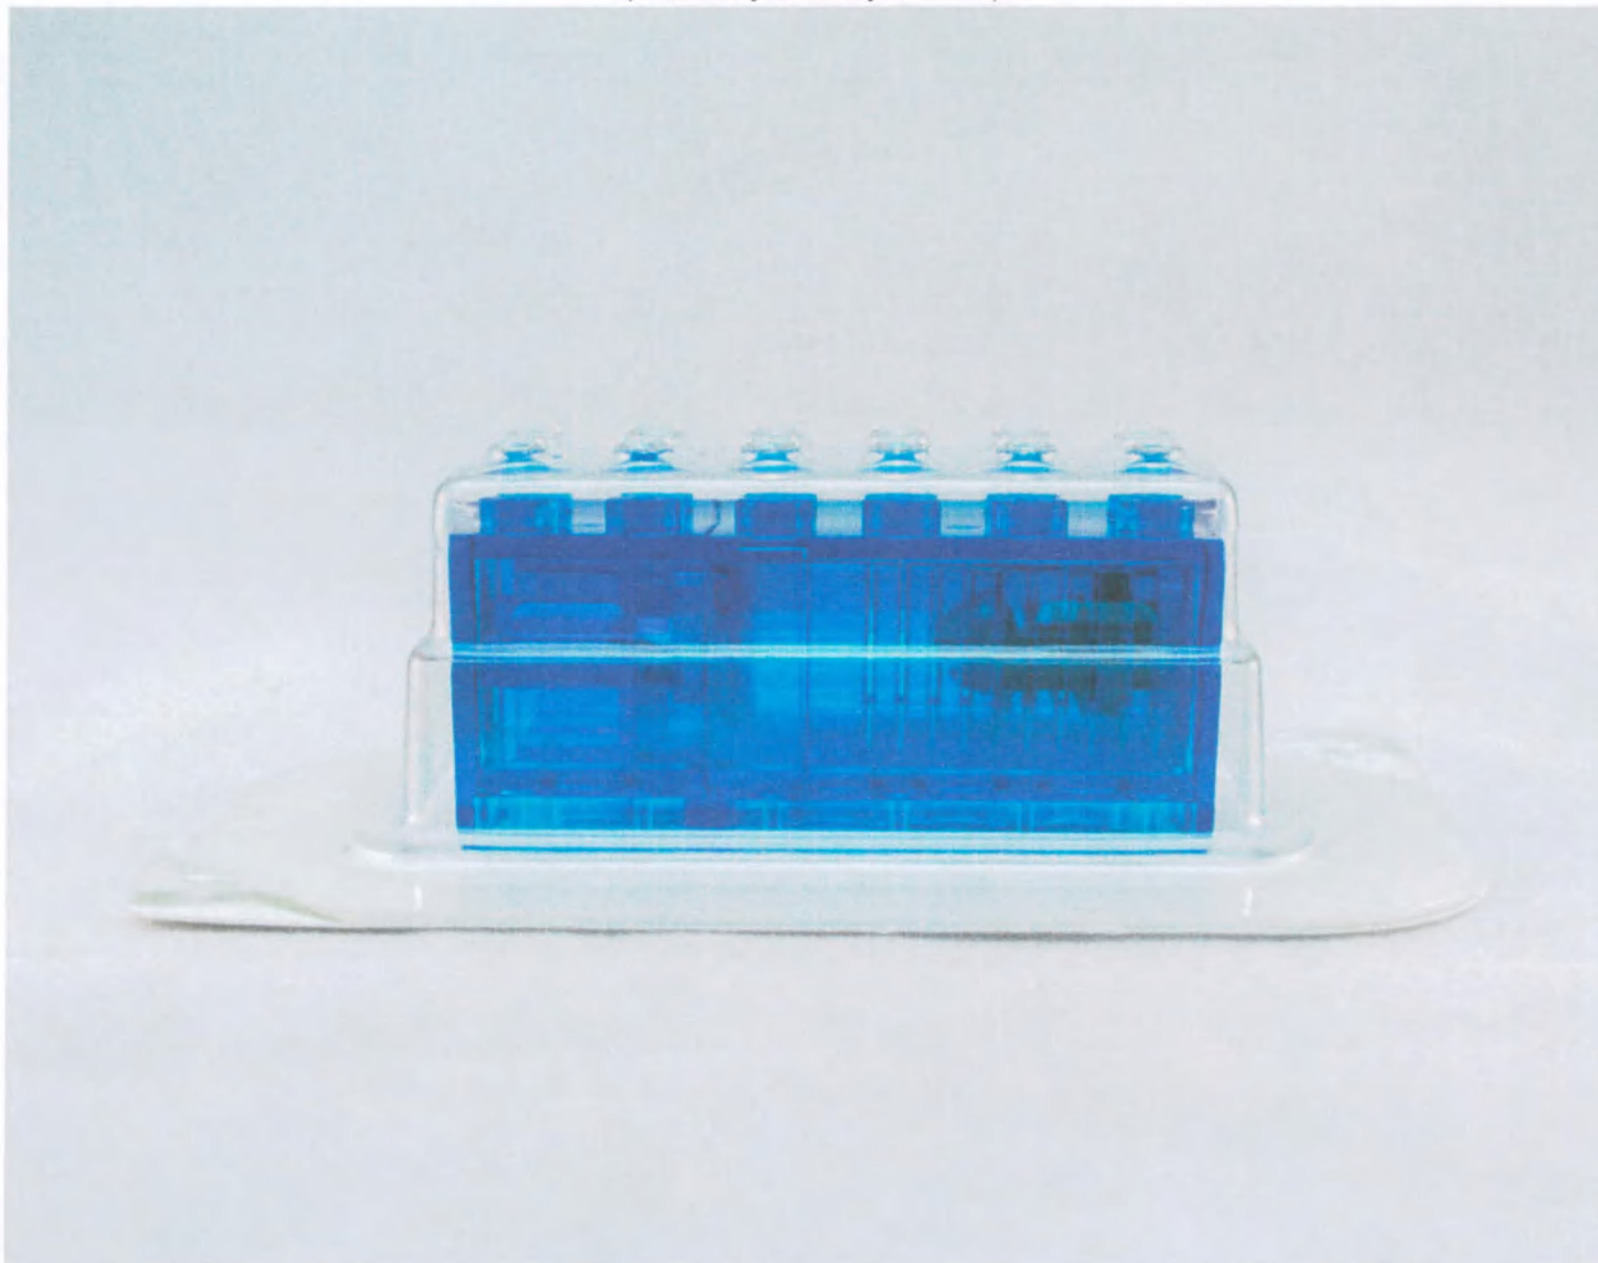

Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)
(индивидуальная упаковка - маркировка)



UDI		MD	XPEED AnyRidge® Internal Fixture	REF	FANIHS5511SC
			(C3.4) Ø3.5/ L7.0	LOT	170403A0381-01
				SN	002
				UDI-DI	(01)08806388220649

UDI		MD	XPEED AnyRidge® Internal Fixture	REF	FANIHS5511SC
			(C3.4) Ø3.5/ L7.0	LOT	170403A0381-01
				SN	002
				UDI-DI	(01)08806388220649



XPEED AnyRidge® Internal Fixture	
(C3.4) Ø3.5/ L7.0	
REF	FANIHS5511SC
LOT	170403A0381-01

XPEED AnyRidge® Internal Fixture	
(C3.4) Ø3.5/ L7.0	
REF	FANIHS5511SC
LOT	170403A0381-01


Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture),
Винт-заглушка (Cover Screw).



Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)
(потребительская упаковка)



Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)
(потребительская упаковка - оборотная сторона)



Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)

Макет маркировки на русском языке

Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)


РУ № ххххх от дд. мм. гггг.

Производитель: МегаДжен Имплант Ко., Лтд., 45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu 42921, Korea

Уполномоченный представитель в России: ООО «ИМПЛАНТ ТРЕЙД», 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7.

Осторожно! Перед использованием, обратитесь к инструкции по применению!

Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)
(индивидуальная упаковка)



Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)
(индивидуальная упаковка - маркировка)

UDI		MD	MiNi™ Internal Fixture	MODEL NAME	MIF3311
			(C3.4) Ø3.5/ L7.0	LOT	170403A0381-01
				SN	002
				UDI-DI	(01)08806388220649

UDI		MD	MiNi™ Internal Fixture	MODEL NAME	MIF3311
			(C3.4) Ø3.5/ L7.0	LOT	170403A0381-01
				SN	002
				UDI-DI	(01)08806388220649

MiNi™ Internal Fixture	
(C3.4) Ø3.5/ L7.0	
MODEL NAME	MIF3311
LOT	170403A0381-01

MiNi™ Internal Fixture	
(C3.4) Ø3.5/ L7.0	
MODEL NAME	MIF3311
LOT	170403A0381-01



Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)
Винт-заглушка (Cover Screw)



II. Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)
(потребительская упаковка)



Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)
(Потребительская упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Мембрана i-Gen
(i-Gen membrane)
Тип B3

REF IG2W1323 2023-06-16 SN 002
LOT 230616A3251-01 2028-06-15 STERILE R

Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки
Осторожно
Не использовать повторно
Не стерилизовать повторно

Rx Only


(01)08806388221714
(11)230616
(17)280615
(10)230616A3251-01
(21)002
(240)IG2W1323
rev.01

MegaGen Implant Co., Ltd

MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)
(индивидуальная упаковка)

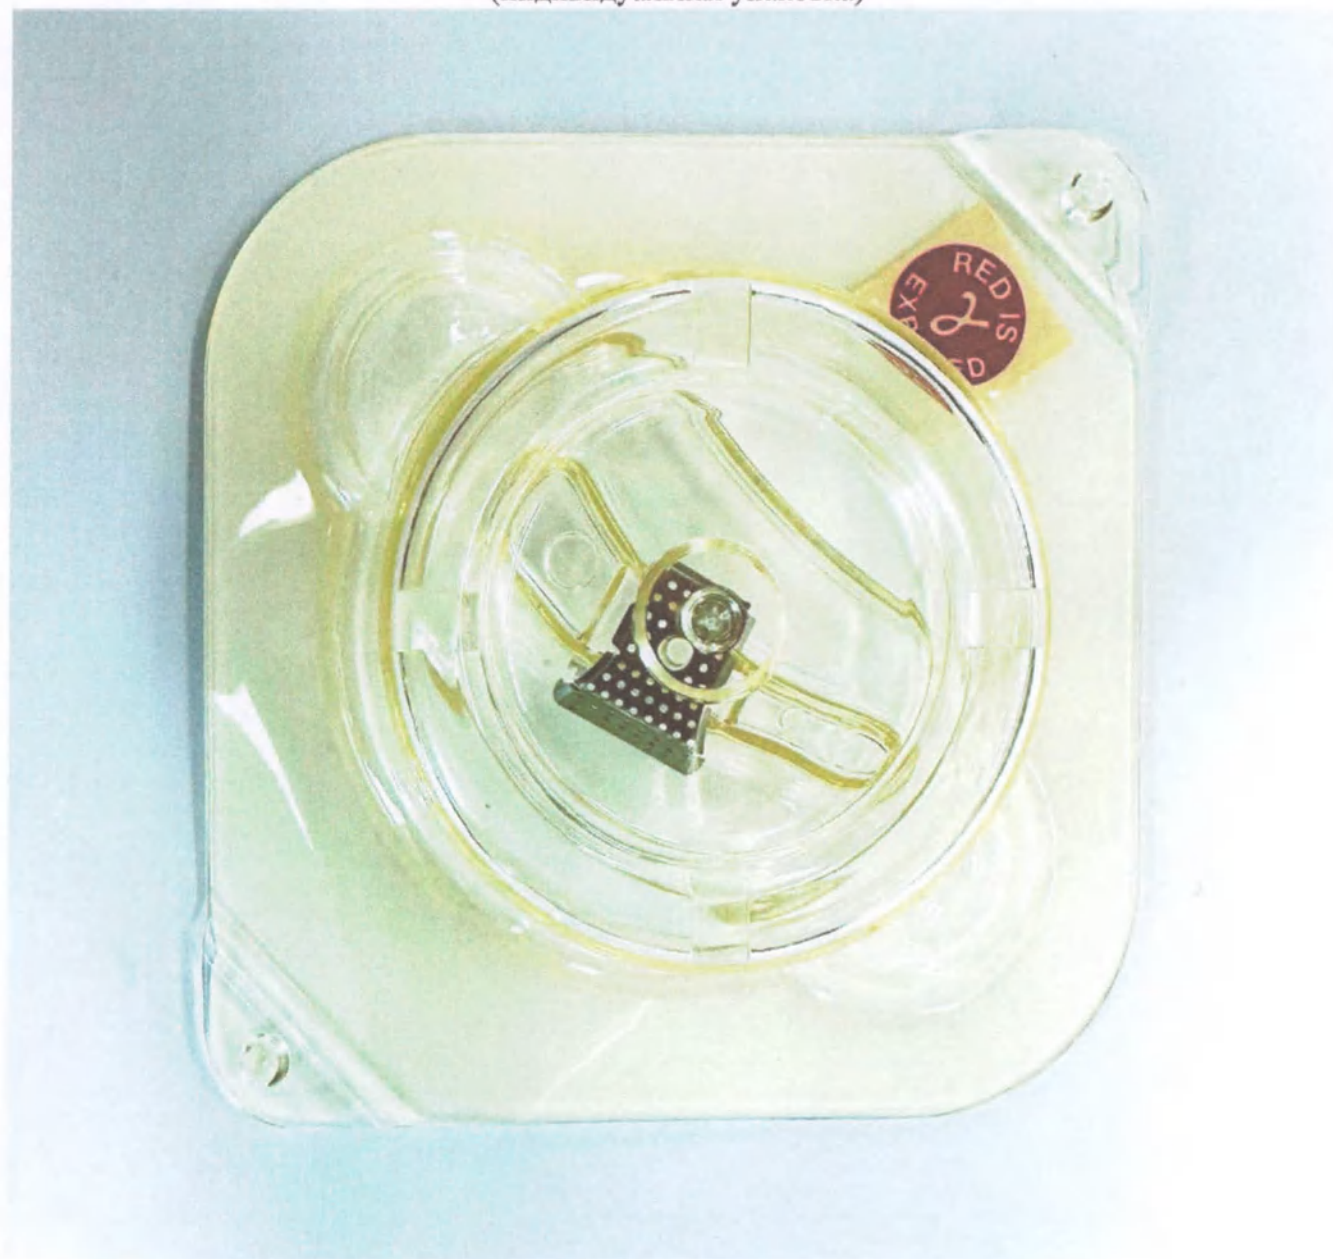

Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Мембрана i-Gen
(i-Gen membrane)
Тип B3

REF IG2W1323 **2023-06-16** **SN** 002
LOT 230616A3251-01 **2028-06-15** **STERILE R**

Обратиться к инструкции по применению Не использовать при повреждении упаковки Осторожно Не использовать повторно Не стерилизовать повторно

Rx Only

(01)08806388221714
(11)230616
(17)280615
(10)230616A3251-01
(21)002
(240)IG2W1323

rev.01

MegaGen Implant Co., Ltd

EC REP MOSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7


Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)




III. Компоненты ортопедические (Prosthetic Components):

Абатмент временный (Temporary Abutment),

Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент временный (Temporary Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент временный (Temporary Abutment),
Винт абатмента (Abutment screw)



Абатмент временный (Temporary Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент временный (Temporary Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Temporary Abutment [AR]
Ø4/ Non-hex

REF AANTMN4012T **2023-01-06**

LOT 230106A0932-01

MODEL NAME AANTMN4012 **SN** 141 **rev.02**

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

(01)08806388204274
(11)230106
(10)230106A0932-01
(21)141
(240)AANTMN4012T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

CE 2460

Абатмент временный
(Temporary Abutment) [AR]
Ø4/ Без шестигранника

REF AANTMN4012T **2023-01-06**

LOT 230106A0932-01 **РУ№ XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME AANTMN4012 **SN** 141 **rev.02**

Rx Only

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388204274
(11)230106
(10)230106A0932-01
(21)141
(240)AANTMN4012T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Температурный диапазон
15°C 30°C

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва, ул.
3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

EZ Post Abutment [AR]
Ø5/ C=2/ P=5.5/ Hex

REF AANEPH5025L  2022-12-07

LOT 221207A2501-01

MODEL NAME AANEPH5025 **SN** 241

Rx Only

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use


 Do not use if package is damaged

rev.01

(01)08806388201358
(11)221207
(10)221207A2501-01
(21)241
(240)AANEPH5025L

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 Temperature limitation

CE 2460

Абатмент EZ Post
(EZ Post Abutment) [AR]
Ø5/ C=2/ P=5.5/ Шестигранник

REF AANEPH5025L  2022-12-07

LOT 221207A2501-01 **РУ№** XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME AANEPH5025 **SN** 241

Rx Only

 Не использовать повторно

 Не стерильно

 Осторожно

 Обратитесь к инструкциям по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

rev.01

(01)08806388201358
(11)231207
(10)221207A2501-01
(21)241
(240)AANEPH5025L

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


 Температурный диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва, ул.
3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

Абатмент ССМ (CCM Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент ССМ (CCM Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)

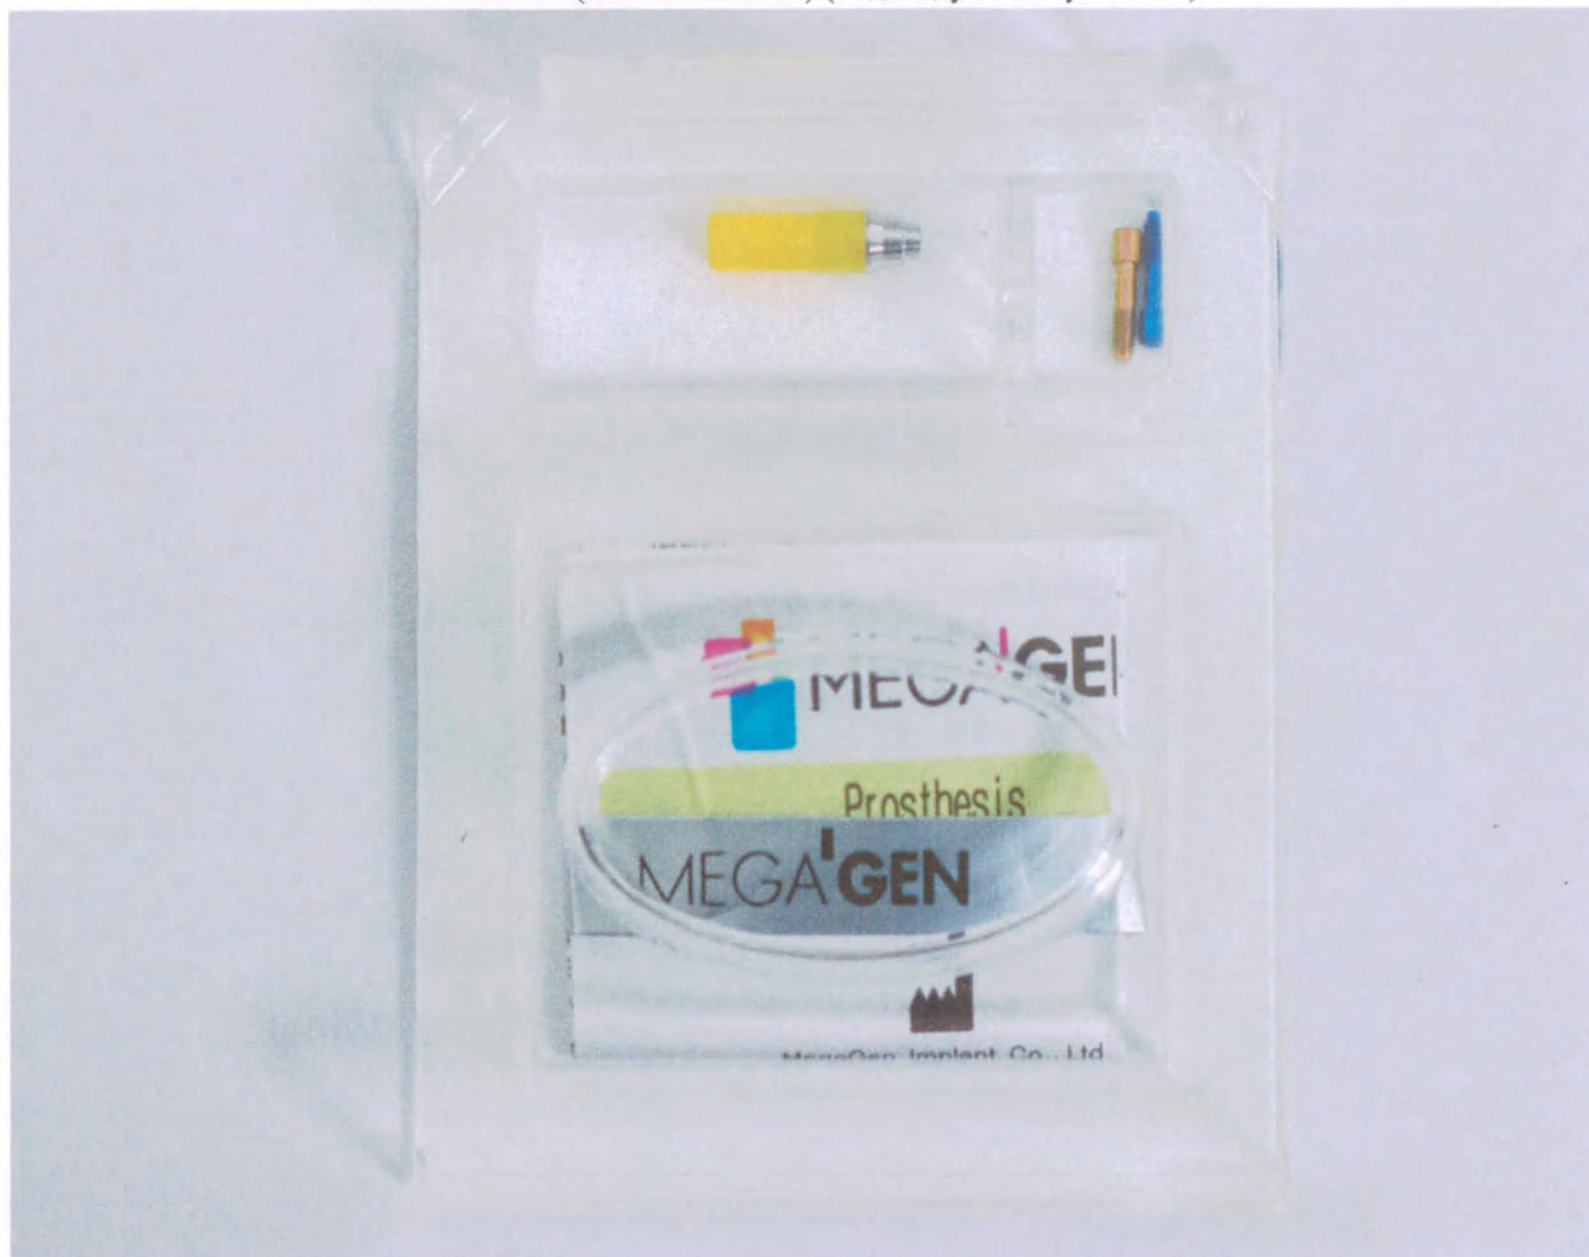

Абатмент CCM (CCM Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

CCM Abutment [AR]
Ø4/ L=12/ Hex

REF AANCAH4012L  2023-07-21

LOT 230721A0872-01

MODEL NAME AANCAH4012 **SN** 014 **rev.02**

Rx Only

 Do not reuse  Non-sterile


 Caution  Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388201013
(11)230721
(10)230721A0872-01
(21)014
(240)AANCAH4012L

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE 2460

Абатмент CCM (CCM Abutment) [AR]
Ø4/ L=12/ Шестигранный

REF AANCAH4012L  2023-07-21

LOT 230721A0872-01 **РУ№** XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

MODEL NAME AANCAH4012 **SN** 014 **rev.02**

Rx Only

 Не использовать повторно  Не стерильно

 Осторожно  Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388201013
(11)230721
(10)230721A0872-01
(21)014
(240)AANCAH4012L

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

 15°C 30°C
Температурный диапазон

Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment),
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)



Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment),
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) (индивидуальная упаковка)



Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)

(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)


2460
 Multi-unit Abutment [AR]
 C=3.5/ Straight/ M1.8

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**


REF MUAARN0035C
LOT 230330A2890-01
MODEL NAME MUAARN0035

 2023-03-30
SN 033
rev.00



 Do not reuse


 Non-sterile


Rx Only



 Caution


 Consult instructions for use


 Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 Temperature limitation


2460
 Абатмент Multi-unit
 (Multi-unit Abutment) [AR]
 C=3.5/ Прямой/ M1.8

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**


REF MUAARN0035C
LOT 230330A2890-01
MODEL NAME MUAARN0035

 2023-03-30
SN 033
rev.00



 Не использовать повторно


 Не стерильно


Rx Only


 Осторожно


 Обратитесь к инструкции по применению


 Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 Температурный диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
 ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment),
Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw), Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)



Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment),
Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw), Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) (индивидуальная упаковка)



Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

MEGA'GEN

Multi-unit Angled Abutment [AR]
C=3.5/ A=30/ Hex 2.3

REF MUAARH3035LC

2022-12-08

LOT 221208A4261-01

MODEL-NAME MUAARH3035

SN 004

rev.01



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged

(01)08806388243501
(11)221208
(10)221208A4261-01
(21)004
(240)MUAARH3035LC

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Абатмент Multi-unit угловой
(Multi-unit Angled Abutment) [AR]
C=3.5/ A=30/ Шестигранник 2.3

REF MUAARH3035LC

2022-12-08

LOT 221208A4261-01

РУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

MODEL-NAME MUAARH3035

SN 004

rev.01



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к инструкциям по применению



Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388243501
(11)221208
(10)221208A4261-01
(21)004
(240)MUAARH3035LC

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон


Абатмент обрабатываемый (Milling Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)




Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент обрабатываемый (Milling Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles MEGA'GEN

Milling Abutment [AR]

Ø5/ C=2/ P=9/ Hex

REF AANMAH5029L

2022-12-27

LOT 221227A0711-01

MODEL NAME AANMAH5029

SN 061

rev.01



(01)08806388202799
(11)221227
(10)221227A0711-01
(21)061
(240)AANMAH5029L



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Абатмент обтачиваемый

(Milling Abutment) [AR]

Ø5/ C=2/ P=9/ Шестигранник

REF AANMAH5029L

2022-12-27

LOT 221227A0711-01

ПУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

MODEL NAME AANMAH5029

SN 061

rev.01



(01)08806388202799
(11)221227
(10)210714A2130-01
(21)061
(240)AANMAH5029L



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к ним: труднее по применению



Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон

Абатмент Octa (Octa Abutment)



Абатмент Octa (Octa Abutment)
(Индивидуальная упаковка)



Абатмент Octa (Octa Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Octa Abutment [AR]
Ø4.8/ C=3

REF AANOAF0030  2021-07-14

LOT 210714A2130-01

MODEL NAME AANOAF0030 **SN** 181 rev. 00

Rx Only 

 Do not reuse  Non-sterile

 Caution  Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388203291
(11)210714
(10)210714A2130-01
(21)181
(240)AANOAF0030

EC REF MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

 MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Абатмент Octa (Octa Abutment) [AR]
Ø4.8/ C=3

REF AANOAF0030  2021-07-14

LOT 210714A2130-01

MODEL NAME AANOAF0030 **SN** 181 rev. 00

ПУ № XXXXXX от дд мм гггг

Rx Only 



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратиться к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки

(01)08806388203291
(11)210714
(10)210714A2130-01
(21)181
(240)AANOAF0030

EC REF MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

 MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

 15°C 30°C
Температурный
диапазон

Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment),
Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)


Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment),
Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), Винт абатмента (Abutment Screw)



Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)
Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460
Fuse Abutment [AR]
Ø5.5/ C=4/ 25°/ Hex

REF AFAA5425P  2022-08-30

LOT 220830A4050-01

MODEL NAME AFAA5425 **SN** 004 rev. 00

Rx Only 

 Do not reuse  Non-sterile

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

(01)08806388260447
(11)220830
(10)220830A4050-01
(21)004
(240)AFAA5425P

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460
Абатмент предохраняющий
(Fuse Abutment) [AR]
Ø5.5/ C=4/ 25°/ Шестигранник

REF AFAA5425P  2022-08-30

LOT 220830A4050-01

MODEL NAME AFAA5425 **SN** 004 rev.00

Rx Only 

 Не использовать повторно  Не стерильно

 Осторожно  Обратитесь к инструкции по применению  Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388260447
(11)220830
(10)220830A4050-01
(21)004
(240)AFAA5425P

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

 15°C 30°C
Температурный диапазон

Абатмент угловой (Angled Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент угловой (Angled Abutment)
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент угловой (Angled Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Абатмент угловой (Angled Abutment)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент угловой (Angled Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Angled Abutment [AR]
Ø4/ C=2/ 15°/ Hex

REF AANA AH4215L **2023-01-09**

LOT 230109A2661-01

MODEL-NAME AANA AH4215 **SN** 160

Rx Only

rev. 01

(01)08806388200573
(11)230109
(10)230109A2661-01
(21)160
(240)AANA AH4215L

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

CE 2460

**Абатмент угловой
(Angled Abutment) [AR]**
Ø4/ C=2/ 15°/ Шестигранник

REF AANA AH4215L **2023-01-09**

LOT 230109A2661-01 **РУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL-NAME AANA AH4215 **SN** 160

Rx Only

rev. 01

(01)08806388200573
(11)230109
(10)230109A2661-01
(21)160
(240)AANA AH4215L

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон
15°C 30°C

Абатмент примерочный (Try-in Abutment),
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)



Абатмент примерочный (Try-in Abutment),
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) (индивидуальная упаковка)



Абатмент примерочный (Try-in Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Try-in Abutment [AR]
Straight

REF MUTIAAR00C **2022-08-31**

LOT 220831A3470-01

MODEL NAME MUTIAAR00 **SN** 018 **Rx Only**

Do not reuse **Non-sterile** **Caution** **Consult Instructions for use** **Do not use if package is damaged**

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

rev. 00

(01)08806388252794
(11)220831
(10)220831A3470-01
(21)018
(240)MUTIAAR00C

Temperature limitation

15°C 30°C

CE

Абатмент примерочный
(Try-in Abutment) [AR]
Прямой

REF MUTIAAR00C **2022-08-31**

LOT 220831A3470-01 **ПУН XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME MUTIAAR00 **SN** 018 **Rx Only**

Do not reuse **Non-sterile** **Caution** **Consult Instructions for use** **Do not use if package is damaged**

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


rev. 00

(01)08806388252794
(11)220831
(10)220831A3470-01
(21)018
(240)MUTIAAR00C


Температурный диапазон

15°C 30°C

Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)



Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)
(индивидуальная упаковка)



Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA¹GEN**

Meg-Rhein Abutment [AR]

C=0

REF ADR00 **2022-08-31**

LOT 220831A5290-01

MODEL NAME ADR00 **SN** 011 rev 00

Rx Only

Do not reuse Non-sterile

Caution Consult Instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08806388204854
(11)220831
(10)220831A5290-01
(21)011
(240)ADR00

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Абатмент Meg-Rhein
(Meg-Rhein Abutment) [AR]

C=0

REF ADR00 **2022-08-31**

LOT 220831A5290-01 **ПУН** XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME ADR00 **SN** 011 rev.00

Rx Only

Не использовать повторно Не стерильно

Осторожно Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388204854
(11)220831
(10)220831A5290-01
(21)011
(240)ADR00

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


15°C 30°C
Температурный диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)



Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)
(индивидуальная упаковка)



Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460
Meg-Ball Abutment [AR]
C=3

REF MBAR30 **2021-11-09**

LOT 211109A5570-01

MODEL NAME MBAR30 **SN** 007 rev. 00

Rx Only

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult Instructions for use


 Do not use if package is damaged



(01)08806388273188
(11)211109
(10)211109A5570-01
(21)007
(240)MBAR30

EC REF MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C — 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment) [AR]
C=3

REF MBAR30 **2021-11-09**

LOT 211109A5570-01

MODEL NAME MBAR30 **SN** 007 rev.00

Rx Only

 Не использовать повторно

 Не стерильно

 Осторожно

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки



(01)08806388273188
(11)211109
(10)211109A5570-01
(21)007
(240)MBAR30


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

 15°C — 30°C
Температурный диапазон

Абатмент сканируемый (Scan Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)

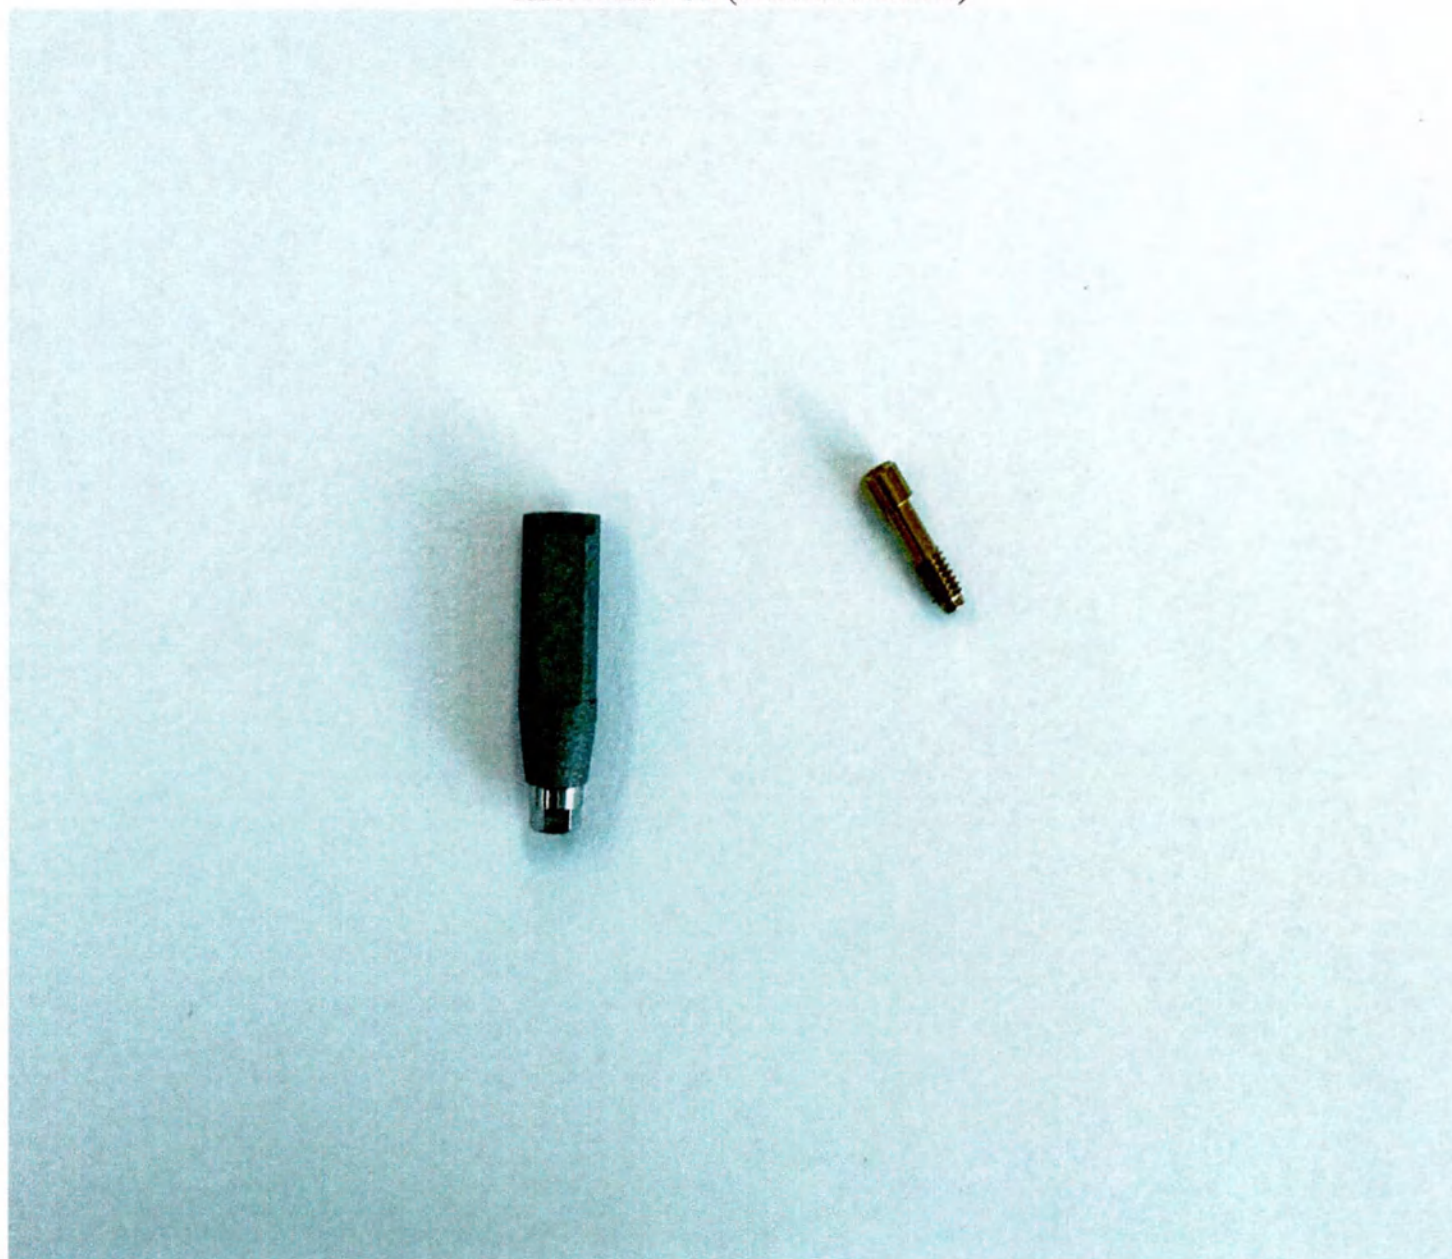

Абатмент сканируемый (Scan Abutment)
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент сканируемый (Scan Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)




Абатмент сканируемый (Scan Abutment)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент сканируемый (Scan Abutment),
Винт цилиндра (Cylinder Screw)



Абатмент сканируемый (Scan Abutment)
Винт цилиндра (Cylinder Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент сканируемый (Scan Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Scan Abutment [AR]
Ø4/ L=13

REF AANISR4013T **2023-01-06**

LOT 230106A4403-01

MODEL NAME AANISR4013 **SN** 122 **rev.03**

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

(01)08806388202553
(11)230106
(10)230106A4403-01
(21)122
(240)AANISR4013T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15 °C 30 °C
Temperature limitation



Абатмент сканируемый
(Scan Abutment) [AR]
Ø4/ L=13

REF AANISR4013T **2023-01-06**

LOT 230106A4403-01 **ПУН: XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME AANISR4013 **SN** 122 **rev.03**

Rx Only

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388202553
(11)230106
(10)230106A4403-01
(21)122
(240)AANISR4013T


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 126124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

15 °C 30 °C
Температурный диапазон

Абатмент сканируемый Тип С (Scan Abutment C-type),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)

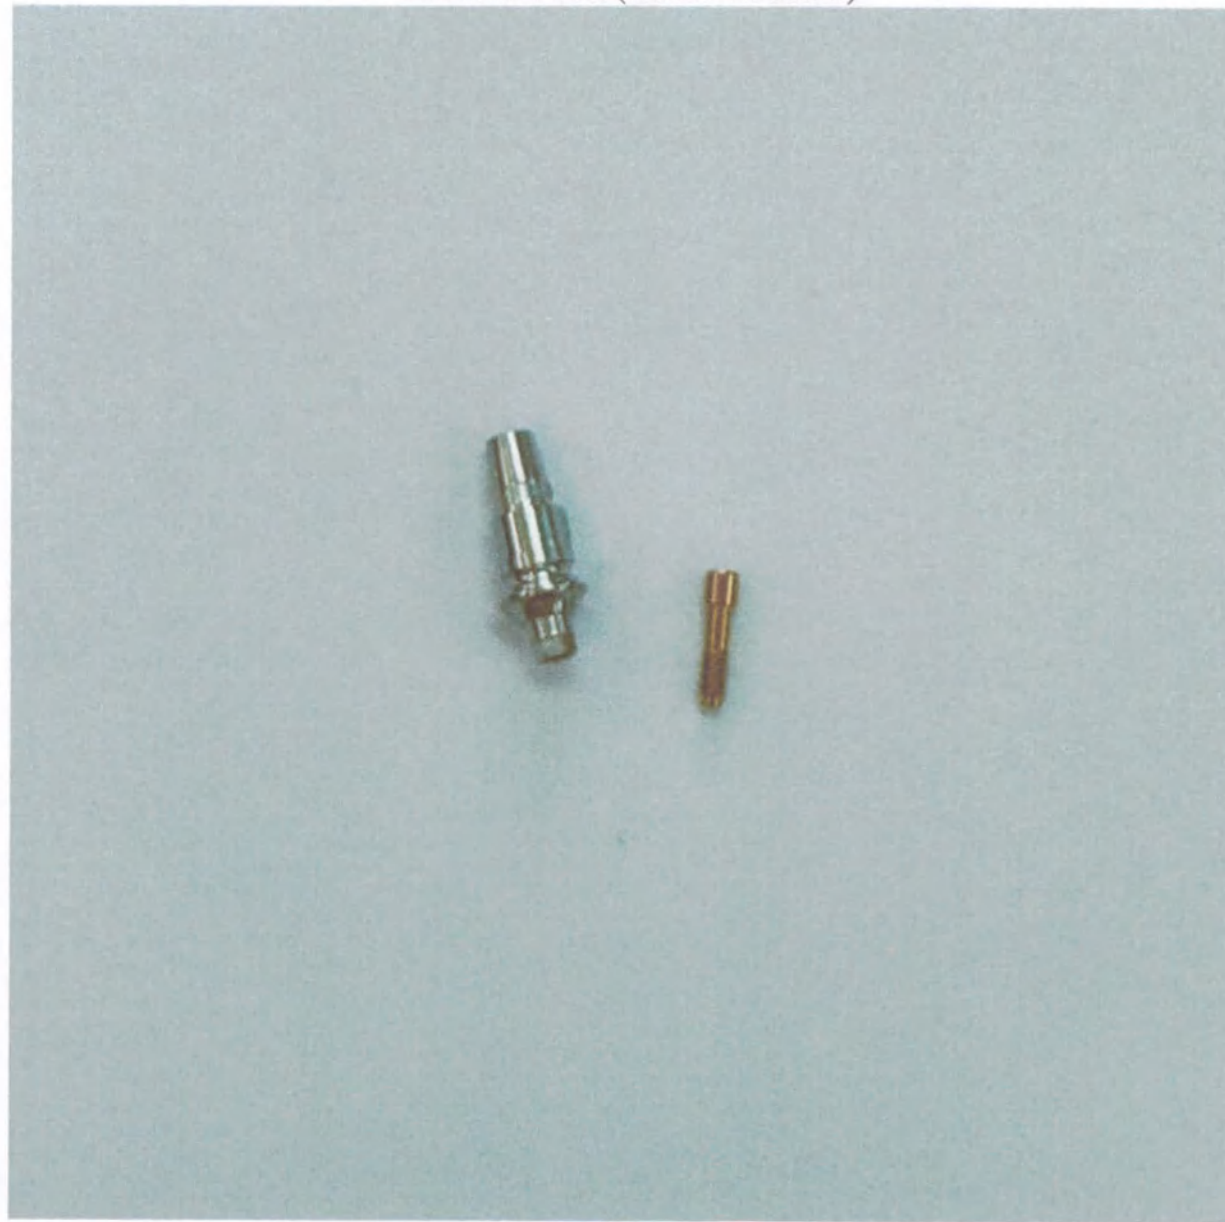


Абатмент сканируемый Тип С (Scan Abutment C-type),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент сканируемый Тип С (Scan Abutment C-type)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Абатмент сканируемый
(Scan Abutment) [AR]
Ø5.5/ C=1/ L/ тип С



Абатмент премил (TiGen Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Абатмент премил (TiGen Abutment)
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7-gil, Dalseong-gun, Daegu,
42921 Republic of Korea
Tel. 82-53-222-2828 Fax. 82-53-289-3420

CE
2460

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex

MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

TiGEN Abutment

Ø10/ L=20/ Non-Hex


MODEL NAME ARTR1020N REF ARTR1020N MTN

LOT 220518A9000-01 SN 010

Абатмент премил (TiGen Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Абатмент премил (TiGen Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Абатмент премил (TiGen Abutment)
(Потребительская упаковка)



MEGAGEN
DIGITAL
PRAGMATISM

MEGAGEN
DIGITAL
PRGMATISMO

MEGAGEN
DIGITAL
PRAGMATISMUS

MEGAGEN
DIGITAL
PRAGMATISME

MEGAGEN
ЦИФРОВОЙ
ПРАГМАТИЗМ

MEGAGEN
DIGITALE
PRAGMATISMO

MEGAGEN
数码
实用主义

MEGAGEN
デジタル
実用主義

메가젠
디지털
실용주의

Абатмент премил (TiGen Abutment)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Абатмент премил (TiGen Abutment) [AR]
Ø10/ L=20/ Без шестигранника

REF ARTR1020N.MTN

2022-05-18

LOT 220518A9000-01

РУ№ XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

MODEL NAME ARTR1020N

SN 010

rev.00



Не использовать
повторно



Не стерильно



Осторожно




Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки

Rx Only



(01)08806388267002
(11)220518
(10)220518A9000-01
(21)010
(240)ARTR1020N.MTN

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15 °C 30 °C
Температурный
диапазон

Винт-заглушка (Cover Screw)



Винт-заглушка (Cover Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт-заглушка (Cover Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Cover Screw [AR]
Ø3.5/ H=0.8

REF AANCSF3508
LOT 220817A2560-01
MODEL NAME AANCSF3508

SN 003
rev. 00

Rx Only
STERILE R

Do not reuse
Do not resterilize
Caution
Consult Instructions for use
Do not use if package is damaged

(01)08806388201211
(11)220817
(17)270816
(10)220817A2560-01
(21)003
(240)AANCSF3508

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 22°C

CE
2460

Винт-заглушка (Cover Screw) [AR]

Ø3.5/ H=0.8

REF AANCSF3508
LOT 220817A2560-01
MODEL NAME AANCSF3508

SN 003
rev. 00

Rx Only
STERILE R

Do not reuse
Do not resterilize
Caution
Consult Instructions for use
Do not use if package is damaged


(01)08806388201211
(11)220817
(17)270816
(10)220817A2560-01
(21)003
(240)AANCSF3508

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 22°C

Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)

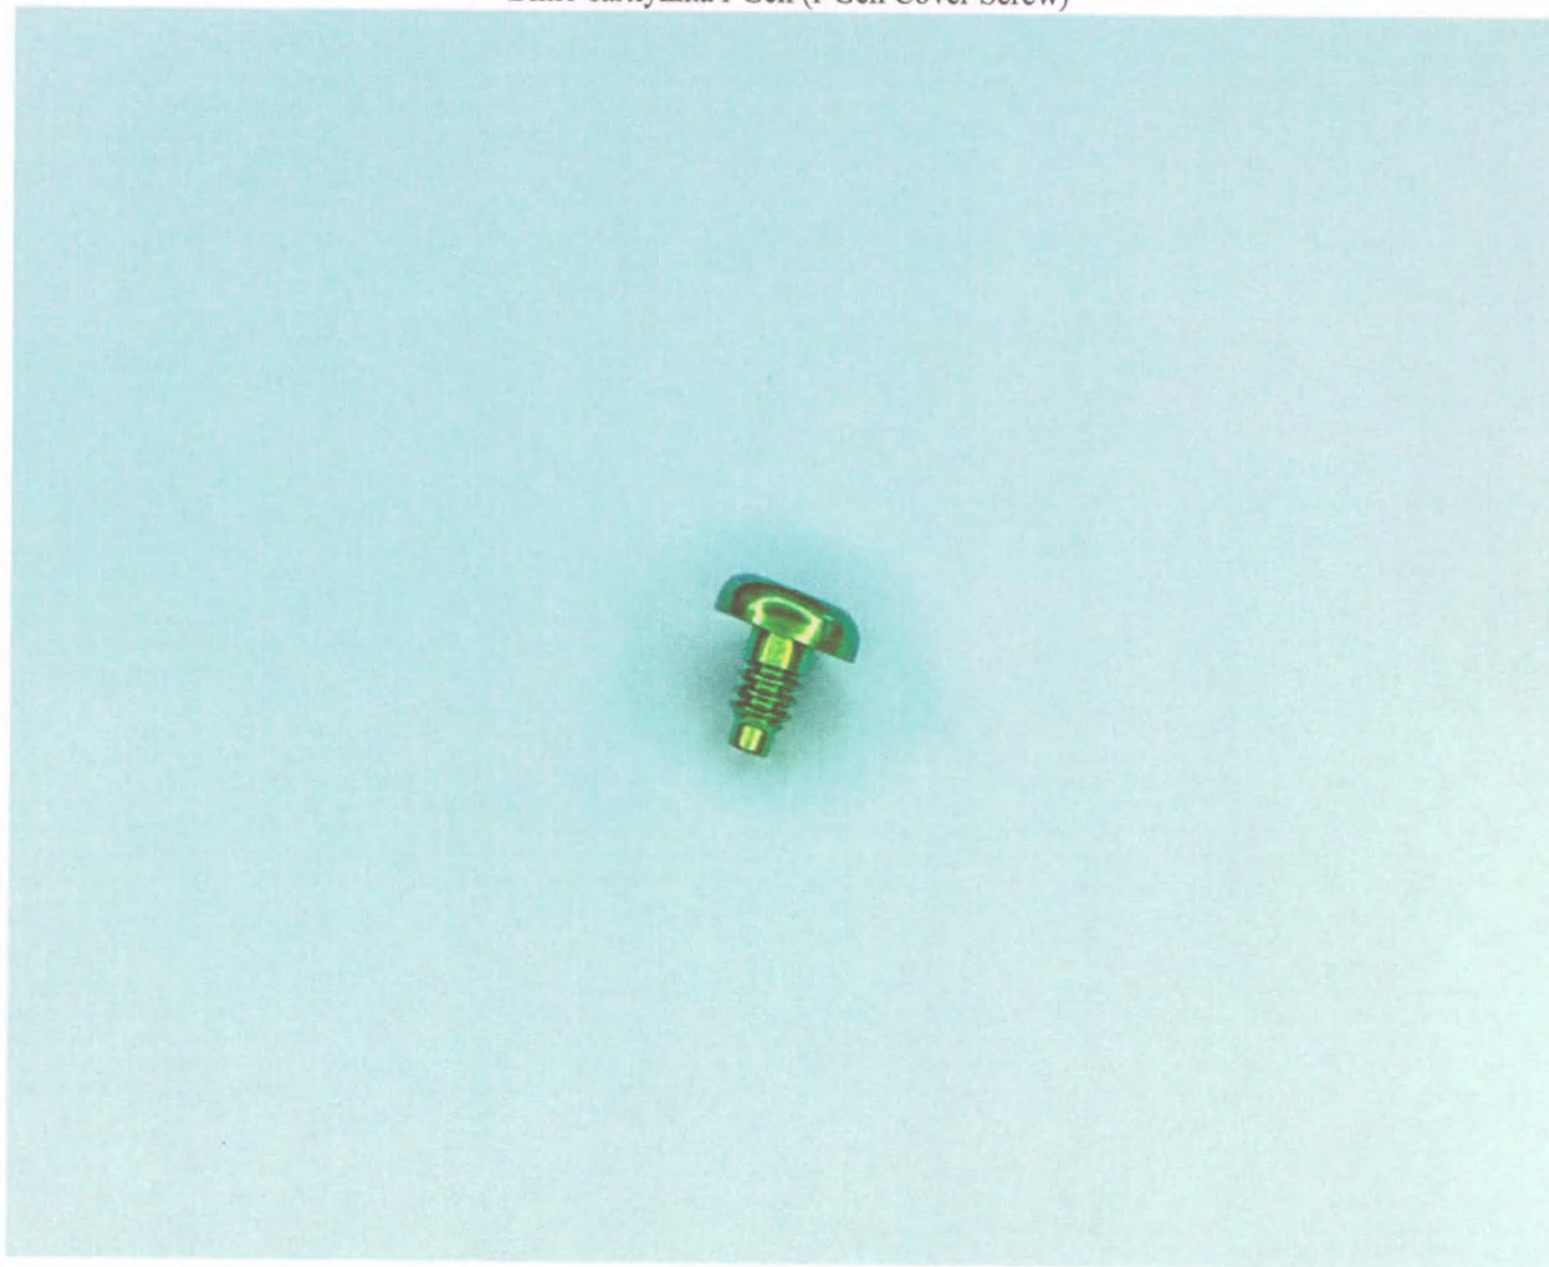

Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

i-Gen Cover Screw
Ø3.5/ H=1

REF ICS3510
LOT 230828A2970-01
MODEL NAME ICS3510

2023-08-28
2028-08-27
SN 121

rev.00

Rx Only
STERILE R

Do not reuse
Do not resterilize
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

(01)08806388220441
(11)230828
(17)280827
(10)230828A2970-01
(21)121
(240)ICS3510

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 22°C
Temperature limitation

CE 2460

Винт-заглушка i-Gen
(i-Gen Cover Screw)
Ø3.5/ H=1

REF ICS3510
LOT 230828A2970-01
MODEL NAME ICS3510

ПУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

2023-08-28
2028-08-27

SN 121

rev.00

Rx Only

STERILE R

Не использовать повторно
Не стерилизовать повторно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388220441
(11)230828
(17)280827
(10)230828A2970-01
(21)121
(240)ICS3510


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

15°C 22°C
Температурный диапазон

Винт i-Gen (i-Gen Screw)



Винт i-Gen (i-Gen Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт i-Gen (i-Gen Screw)

(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

i-Gen Screw
M1.8/ C=1

REF IA1810

LOT 230403A3500-01

MODEL NAME IA1810

 2023-04-03

 2028-04-02

SN 014

Rx Only

STERILE R

 Do not reuse

 Do not re sterilize

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged


rev.00



(01)08806388220212
(11)230403
(17)280402
(10)230403A3500-01
(21)014
(240)IA1810

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea



Temperature limitation

CE 2460

Винт i-Gen (i-Gen Screw) M1.8/ C=1

REF IA1810

LOT 230403A3500-01

MODEL NAME IA1810

РУ № XXXXXX от дд мм гтт

 2023-04-03

 2028-04-02

SN 014

Rx Only

STERILE R

 Не использовать повторно

 Не стерилизовать повторно

 Осторожно

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

rev.00



(01)08806388220212
(11)230403
(17)280402
(10)230403A3500-01
(21)014
(240)IA1810

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea



Температурный диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Винт Multi Post (Multi Post Screw)
(индивидуальная упаковка)




Винт Multi Post (Multi Post Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE 2460

Винт Multi Post
(Multi Post Screw) [AR]
M1.8



Винт абатмента (Abutment Screw)



Винт абатмента (Abutment Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт абатмента (Abutment Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA¹GEN**

Abutment Screw [EX]
M2

REF IRCS200 **2023-05-02**

LOT 230502A4331-01

MODEL NAME IRCS200 **SN** 061 **rev.01**

Rx Only

 Do not reuse  Non-sterile

 Caution  Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388222339
(11)230502
(10)230502A4331-01
(21)061
(240)IRCS200

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 **Temperature limitation**

CE 2460

Винт абатмента (Abutment Screw) [AR]
M2

REF IRCS200 **2023-05-02**

LOT 230502A4331-01 **ПУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME IRCS200 **SN** 061 **rev.01**

Rx Only

 Не использовать повторно  Не стерильно

 Осторожно  Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388222339
(11)230502
(10)230502A4331-01
(21)061
(240)IRCS200


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

 **Температурный диапазон**

Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)



Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Multi-unit Abutment Screw [AR]
M1.8

REF MUAARSF **2022-12-06**

LOT 221206A5300-01

MODEL NAME MUAARSF **SN** 021

Rx Only

rev.00

(01)08806388243976
(11)221206
(10)221206A5300-01
(21)021
(240)MUAARSF

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

CE 2460

Винт абатмента Multi-unit
(Multi-unit Abutment Screw) [AR]
M1.8

REF MUAARSF **2022-12-06**

LOT 2321206A5300-01 **РУ№ XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME MUAARSF **SN** 021

Rx Only

rev.00

(01)08806388243976
(11)221206
(10)2321206A5300-01
(21)021
(240)MUAARSF

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон
15°C 30°C

Винт цилиндра (Cylinder Screw)



Винт цилиндра (Cylinder Screw)
(индивидуальная упаковка)




Винт цилиндра (Cylinder Screw)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)




CE 2460

Винт цилиндра (Cylinder Screw) [CM]
M1.4



Винт S.H.A (S.H.A Screw)

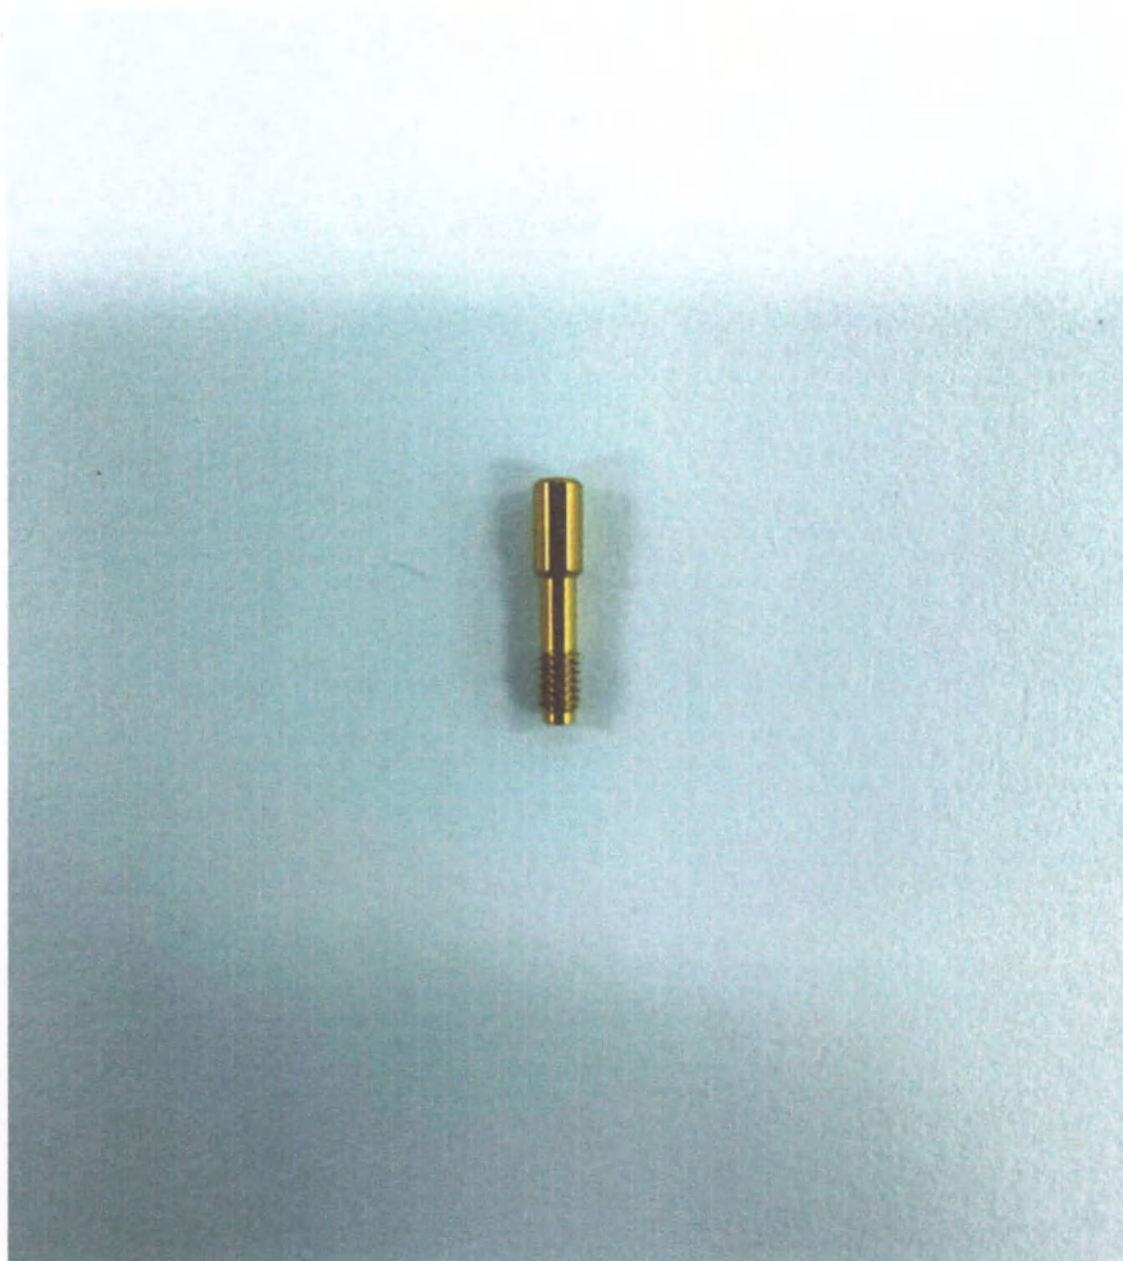

Винт S.H.A (S.H.A Screw)
(индивидуальная упаковка)



Винт S.H.A (S.H.A Screw)

(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)


2460
S.H.A Screw [AR]
M1.8/ H=4

For Lifetime Use **MEGA'GEN**

REF ARIHS1804

LOT 230906A1810-01

MODEL NAME ARIHS1804

 2023-09-06

 2028-09-05

SN 001

rev.00



(01)08806388299751
(11)230906
(17)280905
(10)230906A1810-01
(21)001
(240)ARIHS1804


 Do not reuse


 Do not re-sterilize

Rx Only

STERILE R



 Caution


 Consult instructions for use


 Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dalseong-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


 Temperature limitation


2460
Винт S.H.A (S.H.A Screw) [AR]
M1.8/ H=4

РУ№ XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

 2023-09-06

 2028-09-05

SN 001

REF ARIHS1804

LOT 230906A1810-01

MODEL NAME ARIHS1804

rev.00



(01)08806388299751
(11)230906
(17)280905
(10)230906A1810-01
(21)001
(240)ARIHS1804


 Не использовать повторно


 Не стерилизовать повторно

Rx Only

STERILE R


 Осторожно


 Обратитесь к инструкции по применению


 Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dalseong-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7


 Температурный диапазон

Навигационный пин (Guide Pin)



Навигационный пин (Guide Pin)
(индивидуальная упаковка)



Навигационный пин (Guide Pin)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Guide Pin [AR]
Transfer / L=12 / Hex

REF AANGPT12H **2023-09-06**

LOT 230906A1840-01

MODEL NAME AANGPT12H **SN** 001 **rev.00**

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

(01)08806388202065
(11)230906
(10)230906A1840-01
(21)001
(240)AANGPT12H

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Dasa-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Навигационный пин (Guide Pin) [AR]
Закрытая ложка/ L=12/ Шестигранник

REF AANGPT12H **2023-09-06**

LOT 230906A1840-01 **РУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME AANGPT12H **SN** 001 **rev.00**

Rx Only

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388202065
(11)230906
(10)230906A1840-01
(21)001
(240)AANGPT12H

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон

Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer),
Навигационный пин (Guide Pin)



Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer),
Навигационный пин (Guide Pin) (индивидуальная упаковка)




Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Трансфер слепочный для закрытой ложки
(Impression Coping) [AR]
Ø4/ L=12/ Шестигранник/ Закрытая ложка



Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up),
Навигационный пин (Guide Pin)



Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up),
Навигационный пин (Guide Pin) (индивидуальная упаковка)



Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)
(Индивидуальная упаковка: обратная сторона, макет маркировки на русском языке)



For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Impression Coping [AR]

Ø5/ L=12/ Hex/ Pick-up

REF AANIPH5012T

2022-11-24

LOT 221124A5071-01

MODEL NAME AANIPH5012

SN 125

rev. 01



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult instructions for use



Do not use if package is damaged

(01)08806388202430
(11)221124
(10)221124A5071-01
(21)125
(240)AANIPH5012T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15 °C 30 °C
Temperature limitation



Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping) [AR]

Ø5/ L=12/ Шестигранник/ Открытая ложка

REF AANIPH5012T

2022-11-24

LOT 221124A5071-01

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME AANIPH5012

SN 125

rev. 01



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратиться к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388202430
(11)221124
(10)221124A5071-01
(21)125
(240)AANIPH5012T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15 °C 30 °C
Температурный диапазон

Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)



Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)
(индивидуальная упаковка)



Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)
(индивидуальная упаковка со стороны маркировки)



Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)
(индивидуальная упаковка: макет маркировки на русском языке)



Трансфер слепочный металлический
(Stainless Impression Coping)

REF 044CAIN

 2022-06-06

LOT P2206000178

РУ№ XXXXXX от дд мм гггг



Не использовать повторно



Не стерильно




Хранить вдали от
солнечного света



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки



(01)08059224046952

(10)P2206000178

(11)220606



Rhein83 S.R.L. Via Zago, 10/ABC-40128
Bologna, Italy


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)
(Потребительская упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Наименование продукта: Изделие для снятия слепка системы дентальных имплантатов
Модель: Трансфер слепочный металлический 044CAIN
Номер: Смотрите описание
Дата производства: Смотрите описание
Назначение: Компоненты используются для снятия слепка во время имплантации
Импортер: MEGAGEN IMPLANT CO., LTD
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup, Dalseong-gun, Тэгү, 42921, Республика Корея
Производитель: RHEIN 83 S.r.l
(Италия, Via Emilio Zago, 10 40128, Болонья)
Импортируемый продукт: номер декларации Тэгү, номер получения 13-20
Количество в упаковке: 1 набор
Номер регистрации импортера: 1372
Примечание: домашняя страница (ifu.imagagen.com) предоставляет инструкцию по применению
Продукт одноразового использования

Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)



Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)
(индивидуальная упаковка)



Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE**

Snap Impression Coping [AR] Ø5/ P=7

REF AANSIF570  2018-01-26

LOT 180126A0640-01


MODEL NAME AANSIF570 **SN** 054 rev.00

Rx Only 

Do not reuse  Non-sterile 

Caution  Consult Instructions for use  Do not use if package is damaged 

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd. 472 Hanjangu-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do 38552 Republic of Korea

 Temperature limitation



Трансфер слепочный пластиковый
(Snap Impression Coping) [AR]

Ø5/ P=7

REF AANSIF570  2018-01-26

LOT 180126A0640-01

MODEL NAME AANSIF570

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

SN 054 rev.00

Rx Only 



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратиться к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388204052
(11)180126
(10)180126A0640-01
(21)054
(240)AANSIF570

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7



Температурный диапазон

Аналог лабораторный (Lab Analog)



Аналог лабораторный (Lab Analog)
(индивидуальная упаковка)



Аналог лабораторный (Lab Analog)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Lab Analog [AR]
Ø4/ P=4

REF AANSLF440 **2022-01-11**

LOT 220111A0360-01

MODEL NAME AANSLF440 **SN** 001 rev. 00

Rx Only

Do not reuse Non-sterile

Caution Consult Instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08806388204120
(11)220111
(10)220111A0360-01
(21)001
(240)AANSLF440

EC REF MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd. 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup Dalseong-gun Daegu 42921 Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE

Аналог лабораторный (Lab Analog) [AR]
Ø4/ P=4

REF AANSLF440 **2022-01-11**

LOT 220111A0360-01
РУН# XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME AANSLF440 **SN** 001 rev.00

Rx Only

Не использовать повторно Не стерильно

Осторожно Обратитесь к инструкциям по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388204120
(11)220111
(10)220111A0360-01
(21)001
(240)AANSLF440

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd. 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup Dalseong-gun Daegu 42921 Republic of Korea

15°C 30°C
Температурный диапазон

Аналог RP (RP Analog)



Аналог RP (RP Analog)
(индивидуальная упаковка)



Аналог RP (RP Analog)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

RP Analog [AR]
Ø4/ L=9

REF CANIAR4009 **2023-04-14**

LOT 230414A0970-01

MODEL NAME CANIAR4009 **SN** 221

Rx Only

rev.00

(01)08806388211487
(11)230414
(10)230414A0970-01
(21)221
(240)CANIAR4009

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Dasa-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE

Аналог RP (RP Analog) [AR]
Ø4/ L=9

REF CANIAR4009 **2023-04-14**

LOT 230414A0970-01
РУ№ XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME CANIAR4009 **SN** 221

Rx Only

rev.00

(01)08806388211487
(11)230414
(10)230414A0970-01
(21)221
(240)CANIAR4009

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкциям по применению
Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон

Цилиндр временный (Temporary Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Цилиндр временный (Temporary Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Цилиндр временный (Temporary Cylinder),
Винт цилиндра (Cylinder Screw)



Цилиндр временный (Temporary Cylinder),
Винт цилиндра (Cylinder Screw) (индивидуальная упаковка)



Цилиндр временный (Temporary Cylinder)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Temporary Cylinder [AR]
Ø4.8/ Octa

REF AANOTCO5010T  2022-04-05

LOT 220405A9427-01

MODEL NAME AANOTCO5010 **SN** 001 rev. 00

Rx Only 

 Do not reuse  Non-sterile


 Caution  Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388203505
(11)220405
(10)220405A9427-01
(21)001
(240)AANOTCO5010T

EC REF MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C — 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Цилиндр временный
(Temporary Cylinder) [AR]

Ø4.8/ Восьмигранник

REF AANOTCO5010T  2022-04-05

LOT 220405A9427-01

MODEL NAME AANOTCO5010

РУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

SN 001

rev.00

Rx Only 

 Не использовать повторно

 Не стерильно

 Осторожно

 Обратитесь к инструкциям по применению


 Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388203505
(11)220405
(10)220405A9427-01
(21)001
(240)AANOTCO5010T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

 15°C — 30°C
Температурный диапазон

Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)



Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)
(индивидуальная упаковка)



Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Цилиндр выжигаемый
(Burn-out Cylinder) [AR]

Ø5/ Одиночный

REF AANBCS570

2021-02-18

LOT 210218A1390-01

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME AANBCS570

SN 008

rev.00



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к инструкциям по применению



Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388200986
(11)210218
(10)210218A1390-01
(21)008
(240)AANBCS570


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd. 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup Dalseong-gun Daegu 42921 Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Temperature limitation 15°C 30°C
Температурный диапазон

Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)
(Индивидуальная упаковка: обратная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Цилиндр EZ Post
(EZ Post Cylinder) [AR]
Ø4.8/ P=7/ Восьмигранник



EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон

Цилиндр ССМ (CCM Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Цилиндр ССМ (CCM Cylinder)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)

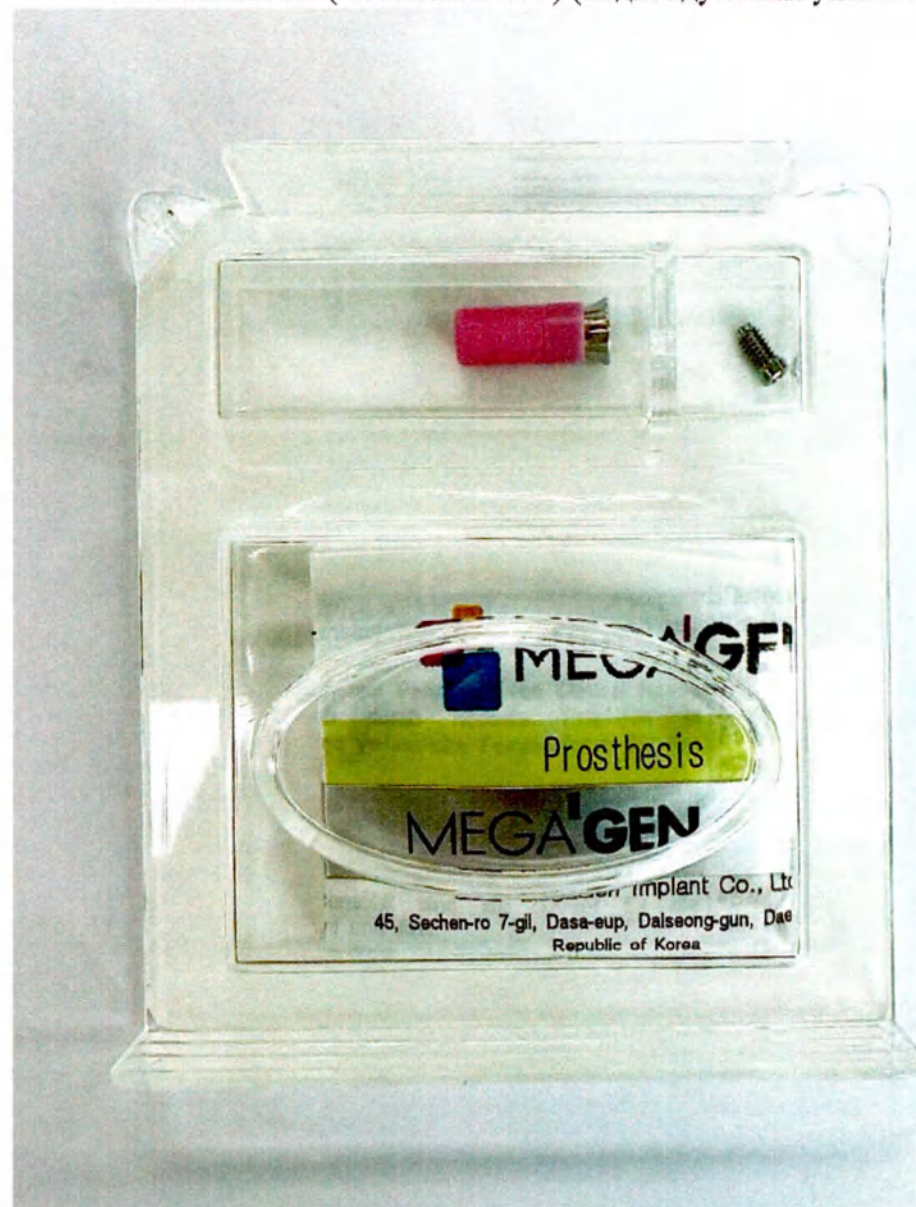

Цилиндр ССМ (CCM Cylinder),
Винт цилиндра (Cylinder Screw)



Цилиндр ССМ (CCM Cylinder)
Винт цилиндра (Cylinder Screw) (индивидуальная упаковка)



Цилиндр CCM (CCM Cylinder)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles MEGA'GEN

CCM Cylinder [AR]
Ø4.8/ Octa

REF AANCCO5000T  2023-05-17

LOT 230517A0660-01

MODEL NAME AANCCO5000 **SN** 001

Rx Only

rev.00

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388201198
(11)230517
(10)230517A0660-01
(21)001
(240)AANCCO5000T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Цилиндр CCM
(CCM Cylinder) [AR]

Ø4.8/ Восьмигранник

REF AANCCO5000T  2023-05-17

LOT 230517A0660-01

MODEL NAME AANCCO5000 **SN** 001

Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Цилиндр пластиковый
(Plastic Cylinder) [AR]

Ø3.8/ Восьмигранник

REF AAOTCO4010T

LOT 200907A3010-01

MODEL NAME AAOTCO4010

2020-09-07

РУН XXXXXX от дд мм гггг

SN 004

rev.00



(01)08806388204816
(11)200907
(10)200907A3010-01
(21)004
(240)AAOTCO4010T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7



Колпачок защитный (Comfort Cap)



Колпачок защитный (Comfort Cap)
(индивидуальная упаковка)



Колпачок защитный (Comfort Cap)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Styles **MEGA'GEN**

Comfort Cap [AR]
Ø4/ P=7

REF AANCCF470 **2021-05-27**

LOT 210527A1350-01

MODEL NAME AANCCF470 **SN** 022 rev. 00

Rx Only

Do not reuse Non-sterile

Caution Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08806388201051
(11)210527
(10)210527A1350-01
(21)022
(240)AANCCF470

EC REF MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Колпачок защитный
(Comfort Cap) [AR]
Ø4/ P=7

REF AANCCF470 **2021-05-27**

LOT 210527A1350-01
РУ№ XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME AANCCF470 **SN** 022 rev.00

Rx Only

Не использовать повторно Не стерильно

Осторожно Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388201051
(11)210527
(10)210527A1350-01
(21)022
(240)AANCCF470

EC REF MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон


Колпачок предохраняющий (Healing Cap),
Винт абатмента (Abutment Screw)



Колпачок предохраняющий (Healing Cap)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)



Колпачок предохраняющий (Healing Cap),
Винт цилиндра (Cylinder Screw)

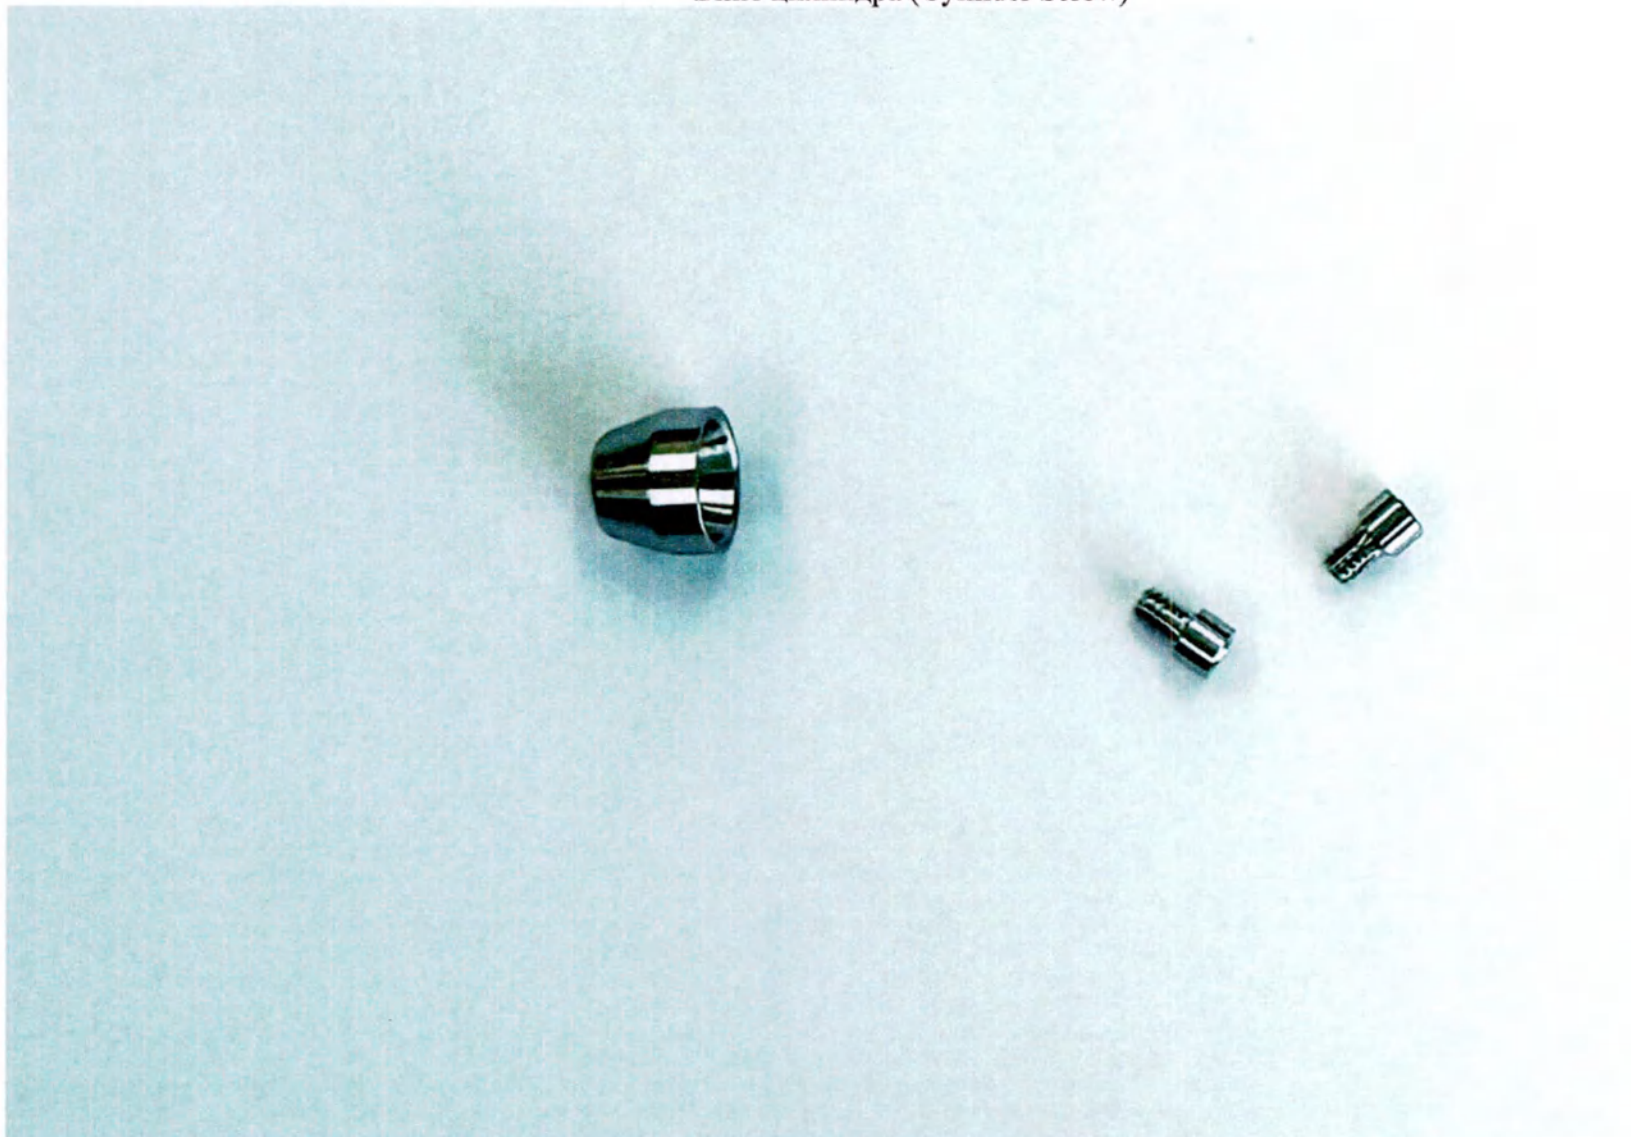

Колпачок предохраняющий (Healing Cap)
Винт цилиндра (Cylinder Screw) (индивидуальная упаковка)



Колпачок предохраняющий (Healing Cap)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)


2460
Healing Cap [AR]
Ø3.8


For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

REF AANOHC4000T
LOT 210329A0040-01
MODEL NAME AANOHC4000

 2021-03-29
SN 004 rev. 00


 Do not reuse


 Non-sterile


Rx Only




 Caution


 Consult
Instructions
for use


 Do not use
if package
is damaged

(01)08806388203420
 (11)210329
 (10)210329A0040-01
 (21)004
 (240)AANOHC4000T

EC REP MDSS GmbH
 Schiffgraben 41
 30175 Hannover Germany
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 Temperature
limitation


2460

**Колпачок предохраняющий
(Healing Cap) [AR]**
Ø3.8

REF AANOHC400T
LOT 210329A0040-01
MODEL NAME AANOHC400

 2021-03-29
 Р/У № XXXXXX от дд мм гггг
SN 004 rev.00


 Не использовать повторно


 Не стерильно


Rx Only




 Осторожно


 Обратитесь к
инструкции по
применению


 Не использовать
при повреждении
упаковки

(01)08806388203420
 (11)210329
 (10)210329A0040-01
 (21)004
 (240)AANOHC400T

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
 30175 Hannover Germany
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 Температурный
диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
 ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Скан пост (Scan Post)




Скан пост (Scan Post)
(индивидуальная упаковка)



Скан пост (Scan Post)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Скан пост (Scan Post) [CM]
Ø6/ L=7



Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)



Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)
(индивидуальная упаковка)



Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE 2460

Колпачок абатмента предохраняющего
(Fuse Cap) [AR]

Ø5.5/ Прямой

REF AFCP

LOT 230906A1820-01

MODEL NAME AFCP

SN 001 **rev.00**

РУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

Rx Only



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к инструкциям по применению



Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388299898
(11)230906
(10)230906A1820-01
(21)001
(240)AFCP

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Temperature limitation: 15°C to 30°C
Температурный диапазон

Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)



Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)
(индивидуальная упаковка)



Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles MEGA'GEN

Metal Housing [CM]
Ø5.0

REF MBHR

LOT 230103A2160-01

MODEL NAME MBHR

SN 004

rev.00

Rx Only

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08806388275694
(11)230103
(10)230103A2160-01
(21)004
(240)MBHR

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature limitation

CE 2460

Металлическая матрица с ретенционным кольцом
(Metal Housing) [AR]
Ø5.0

REF MBHR

LOT 230103A2160-01

MODEL NAME MBHR

SN 004

rev.00

Rx Only

Не использовать повторно

Не стерильно

Осторожно

Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388275694
(11)230103
(10)230103A2160-01
(21)004
(240)MBHR

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

000 Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

15°C 30°C
Температурный диапазон

Ретенционное кольцо (Retentive Ring)



Ретенционное кольцо (Retentive Ring)
(индивидуальная упаковка)



Ретенционное кольцо (Retentive Ring)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460
Retentive Ring [CM]
Ø1.5

REF MBR5 **LOT** 230103A2320-01 **MODEL NAME** MBR

SN 010 **rev.00**

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

CE 2460
Ретенционное кольцо
(Retentive ring) [CM]
Ø1.5

REF MBR5 **LOT** 230103A2320-01 **MODEL NAME** MBR

SN 010 **rev.00**

Rx Only

Не использовать повторно
Не стерильно
Осторожно
Обратитесь к инструкции по применению
Не использовать при повреждении упаковки


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон
15°C 30°C

Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)





Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)
(индивидуальная упаковка)



Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)
(Потребительская упаковка)



Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)
(Потребительская упаковка)



Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)[CM]

Металлическая

REF MHP

LOT 230411A3420-01

MODEL NAME MHP

2023-04-11

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

SN 033

rev.00



Rx Only



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к инструкции по применению




Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388226337
(11)230411
(10)230411A3420-01
(21)033
(240)MHP

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7




Температурный диапазон

Колпачок ретенционный (Retentive Cap)



Колпачок ретенционный (Retentive Cap)
(индивидуальная упаковка)



Колпачок ретенционный (Retentive Cap)
(Потребительская упаковка)



Колпачок ретенционный (Retentive Cap)
(Потребительская упаковка)



Колпачок ретенционный (Retentive Cap)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Колпачок ретенционный
(Retentive Cap) [CM]

Белый

REF RCWP

2023-03-17

LOT 230317A3070-01

MODEL
NAME RCWP

SN 004

rev.00



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use

Rx Only



Do not use
if package
is damaged



(01)08809822762132
(11)230317
(10)230317A3070-01
(21)004
(240)RCWP

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

15°C 30°C
Temperature
limitation

IV. Формирователь десны (Healing Abutment)



Формирователь десны (Healing Abutment)
(индивидуальная упаковка)



Формирователь десны (Healing Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Формирователь десны
(Healing Abutment) [AR]
Ø5/ H=8

REF AANHAF0508
LOT 230106A1420-01
MODEL NAME AANHAF0508

ПУН № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

2023-01-06
2028-01-05

SN 016

rev.00

Не использовать повторно
Осторожно

Не стерилизовать повторно
Обратитесь к инструкции по применению

Rx Only
STERILE R
Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388276004
(11)230106
(17)280105
(10)230106A1420-01
(21)016
(240)AANHAF0508


MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон
15°C 22°C

Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment),
Винт S.H.A (S.H.A Screw)



Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment),
Винт S.H.A (S.H.A Screw) (индивидуальная упаковка)



Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE
2460

Формирователь десны сканируемый
(Scan Healing Abutment) [AR]

Ø5/ H=7

REF ARISH5007T

LOT 221208A4760-01

MODEL NAME ARISH5007



Не использовать повторно



Осторожно

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

ПУН № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

REF ARISH5007T

LOT 221208A4760-01

MODEL NAME ARISH5007

Rx Only

STERILE R



Не использовать повторно

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7

rev.00



(01)08806388250264
(11)221208
(17)271207
(10)221208A4760-01
(21)090
(240)ARISH5007T




Температурный диапазон

Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)



Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)
(индивидуальная упаковка)



Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



V. Титановое основание (ZrGen Abutment)

Титановое основание (ZrGen Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Титановое основание (ZrGen Abutment),
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)




MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Meigen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7-gil, Daejeon-gu, Daejeon, 42921 Republic of Korea
Tel. 82-53-222-2828 Fax. 82-53-289-3420

CE
2460

ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		
ZrGEN Abutment MODEL: 04/ C=0.6/ P=4.5 NAME: AANIPR4015 LOT: 230417A0100-01 REF: AANIPR4015.MTN SN: 029		


Титановое основание (ZrGen Abutment),
Винт абатмента (Abutment Screw)

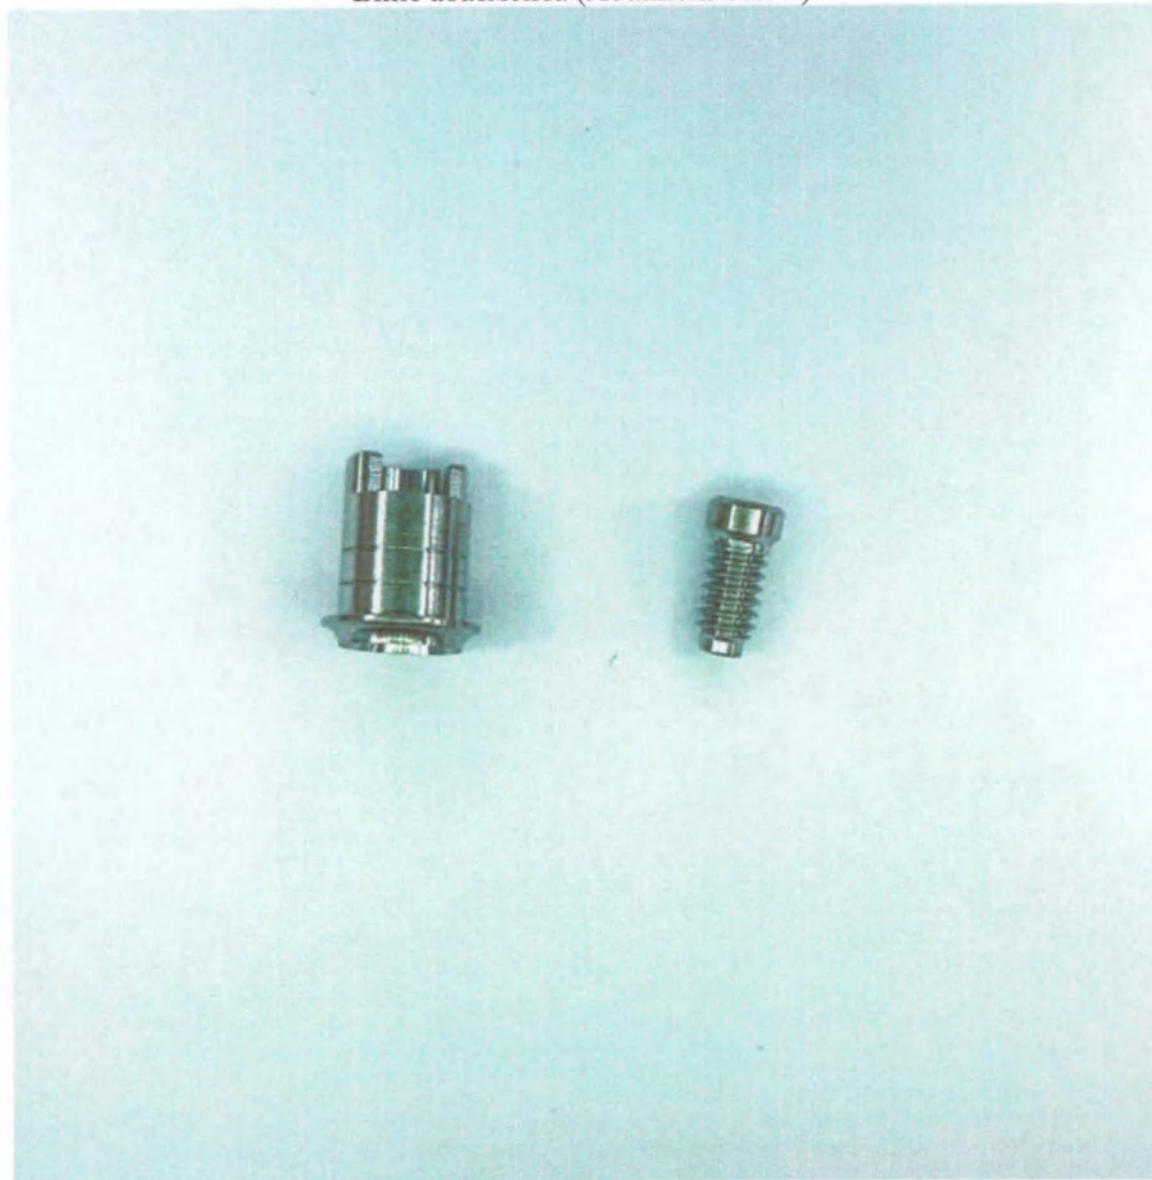

Титановое основание (ZrGen Abutment)
Винт абатмента (Abutment Screw) (индивидуальная упаковка)





Титановое основание (ZrGen Abutment),
Винт цилиндра (Cylinder Screw)



Титановое основание (ZrGen Abutment)
Винт цилиндра (Cylinder Screw) (индивидуальная упаковка)



Титановое основание (ZrGen Abutment)
(Потребительская упаковка)



Титановое основание (ZrGen Abutment)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Титановое основание
(ZrGen Abutment) [AR]

Ø4/ C=0.6/ P=4.5

REF AANIPR4015.MTN

LOT 230417A0100-01

MODEL NAME AANIPR4015

2023-04-17

РУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

SN 029

rev.00

Rx Only



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки




(01)08806388244652
(11)230417
(10)230417A0100-01
(21)029
(240)AANIPR4015.MTN

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7



Температурный
диапазон

Титановое основание Тип С (ZrGen Abutment C-Type),
Винт Multi Post (Multi Post Screw)



Титановое основание Тип С (ZrGen Abutment C-Type)
Винт Multi Post (Multi Post Screw) (индивидуальная упаковка)



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

MedGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7-gil, Daejeon-gu,
Daejeon, 42921 Republic of Korea
Tel: 82-53-222-2828 Fax: 82-53-289-3420

CE
2460

ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007
ZrGEN Abutment	
03.9/ C=1/ S/ C-type MODEL ARCS3410 NAME LOT 230202A0330-01	REF ARCS3410 MTN SN 007



**Environment Friendly
MEGAGEN Implant**



MEGAGEN

ZrGEN Abutment [AR]

03.9/ C=1/ S/ C-type

REF ARCS3410 MTN

LOT 230202A0330-01

MODEL NAME ARCS3410

EXP. 03

SN 007

Rx Only

2023-02-02



(01)J8B0P398245314
(11)230202
(10)230202A0330-01
(21)007
(20)ARCS3410 MTN

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Do not use
if package
is damaged

Consult
instructions
for use

18°C



Temperature
Insulation

CC-MEP

MOSES GmbH

Grünpfad 41

30175 Hannover Germany

Do not use
if package
is damaged

Consult
instructions
for use

MOSES GmbH

Grünpfad 41

30175 Hannover Germany

Megagen Implant Co. Ltd.

100, Seongnam-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do

42621

Republic of Korea

메가젠
디지털
실용주의

Титановое основание Тип С (ZrGen Abutment C-Type)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Титановое основание Тип С
(ZrGen Abutment C-Type) [AR]

Ø3.9/ C=1/ S/ Тип С

REF ARCS3410.MTN

2023-02-02

LOT 230202AD330-D1

ПУНXXXXXX 07 АДММ ГГГГ

MODEL NAME ARCS3410

SN 007

rev.00



Не использовать с другими продуктами



Не использовать с другими продуктами



Осторожно



Обратитесь к инструкции до применения



Не использовать с другими продуктами

Rx Only



(01)08906388245314
(11)230202
(10)230202AD330-D1
(21)007
(240)ARCS3410.MTN

ADSS GmbH Schillingstraße 1
30475 Hannover Germany



MeosGen Implant Co. Ltd.
as Seachem-ro 7gi Deae-ro
Daejeon-gu Daejeon 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г Москва,
ул 3-я Ямского поля, д 18, пом III, ком 7



Температурный диапазон

VI. Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)



Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)
(индивидуальная упаковка)



Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Meg-Ball Package [AR]
C=0

REF MBAR00P **2023-03-10**

LOT 230310A1790-01

MODEL NAME MBAR00P **SN** 001

Rx Only

rev.00

(01)08806388275281
(11)230310
(10)230310A1790-01
(21)001
(240)MBAR00P

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

CE
2460

Набор Meg-Ball для съемного
протезирования (Meg-Ball Package) [AR]
C=0

REF MBAR00P **2023-03-10**

LOT 230310A1790-01
РУНХ ХХХХХХ от дд мм гггг

MODEL NAME MBAR00P **SN** 001

Rx Only

rev.00

(01)08806388275281
(11)230310
(10)230310A1790-01
(21)001
(240)MBAR00P

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон
15°C 30°C

VII. Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)




Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)
(индивидуальная упаковка)



Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)
(Потребительская упаковка)



Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)
(Потребительская упаковка)



Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)
(Потребительская упаковка: макет маркировки на русском языке)

CE
2460

Набор Meg-Rhein для съемного протезирования
(Meg-Rhein Overdenture System) [AR] C=6

REF ADR06P

LOT 230324A0230-01

MODEL
NAME ADR06P

2023-03-24

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

SN 037

Rx Only

rev.00



(01)08806388204984
(11)230324
(10)230324A0230-01
(21)037
(240)ADR06P



Не использовать повторно



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к
инструкции по
применению




Не использовать
при повреждении
упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д.18, пом. III, ком. 7



Температурный
диапазон

VIII. Инструменты стоматологические (Dental Instruments):
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)



Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)
(индивидуальная упаковка)



Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Multi-unit Carrier [CM]

Ø4/ L=13

REF MUASC

2023-05-18

LOT 230518A1520-01

MODEL NAME MUASC

SN 001

rev.00



(01)08806388244003
(11)230518
(10)230518A1520-01
(21)001
(240)MUASC

Rx Only



Caution



Non-sterile



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Dalseong-gun,
Daegu, 42921,
Republic of Korea



Temperature
limitation



Инструмент для введения Multi-unit
(Multi-unit Carrier) [CM]

Ø4/ L=13

REF MUASC

2023-05-18

LOT 230518A1520-01

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME MUASC

SN 001

rev.00



(01)08806388244003
(11)230518
(10)230518A1520-01
(21)001
(240)MUASC

Rx Only



Осторожно



Не стерильно



Обратитесь к
инструкциям по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7



Температурный
диапазон

Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)




Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)
(индивидуальная упаковка)



Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)



Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)
(индивидуальная упаковка)




Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Отвертка для извлечения Multi-unit
(Multi-unit Removal Driver) [AR]
Шестигранник 1.2/ L=20



Отвертка ручная (Hand Driver)

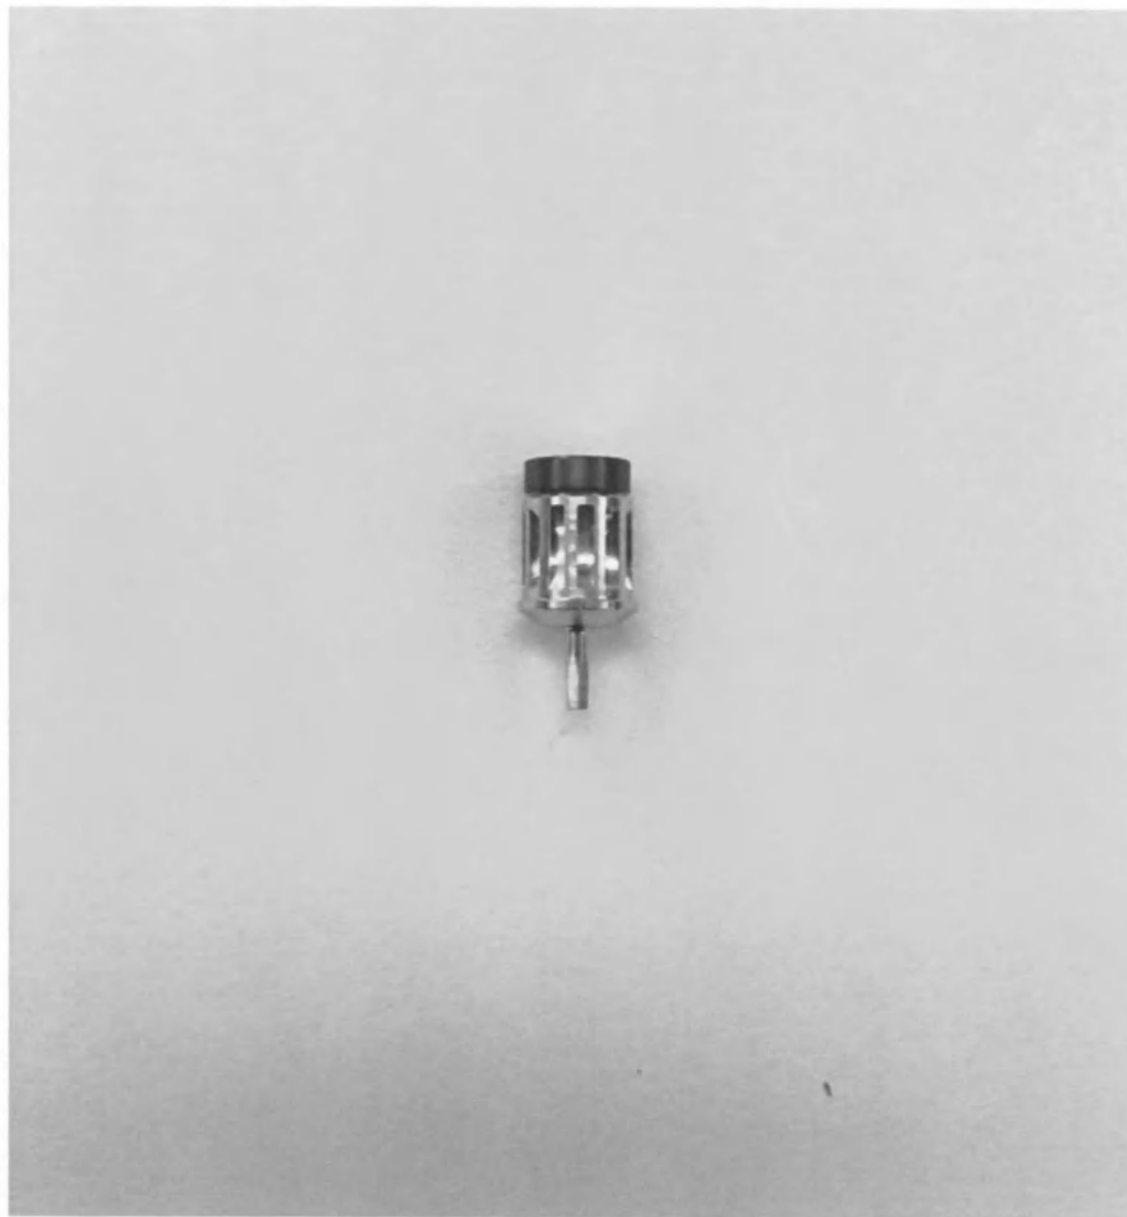


Отвертка ручная (Hand Driver)
(индивидуальная упаковка)




Отвертка ручная (Hand Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Отвертка ручная (Hand Driver) [CM]
Шестигранник 1.2/ Ультра-короткая



Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)




A clear plastic surgical instrument tray, likely a SteriPack, is shown. Inside the tray, a scalpel with a silver handle and a sharp blade is visible. Below the scalpel, there is a card with the MEGA'GEN logo and text. The card includes the company name "MEGA'GEN", the phrase "Surgical Instruments", and contact information for the company in the Philippines. The tray is sealed and appears to be a sterile package for the instrument.

Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE

Отвертка машинная Multi-unit
(Right Angle Driver Multi-unit) [MUA/CM]
Шестигранник 2/ L=10



Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)



Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)
(индивидуальная упаковка)



Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Impression Driver [CM]
Short

REF TCMID **2021-11-30**

LOT 211130A2460-01

MODEL NAME TCMID **SN** 007 rev. 00

Rx Only


 Caution  Non-sterile

 Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

(01)08806388238798
(11)211130
(10)211130A2460-01
(21)007
(240)TCMID

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation



Отвертка для слепочного трансфера
(Impression Driver) [CM]

Короткая

REF TCMID

2021-11-30

LOT 211130A2460-01

ПУ № XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME TCMID

SN 007

rev.00

Rx Only



Осторожно



Не стерильно



Обратиться к инструкциям по применению




Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388238798
(11)211130
(10)211130A2460-01
(21)007
(240)TCMID

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7



Температурный диапазон

Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)



Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)
(индивидуальная упаковка)



Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Abutment Removal Driver
M1.8/ Short

REF TANMRD18 **2023-05-18**

LOT 230518A3162-01

MODEL NAME TANMRD18 **SN** 001

Rx Only

rev.02

Caution

Non-sterile

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Dasa-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

(01)08806388237708
(11)230518
(10)230518A3162-01
(21)001
(240)TANMRD18

CE

Отвертка для извлечения абатмента
(Abutment Removal Driver)
M1.8/ Короткая

REF TANMRD18 **2023-05-18**

LOT 230518A3162-01 **РУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME TANMRD18 **SN** 001

Rx Only

rev.02

Caution

Non-sterile

Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41, 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Температурный диапазон

15°C 30°C

(01)08806388237708
(11)230518
(10)230518A3162-01
(21)001
(240)TANMRD18

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Отвертка Octa (Octa Driver)



Отвертка Octa (Octa Driver)
(индивидуальная упаковка)



Отвертка Octa (Octa Driver)
(Индивидуальная упаковка: обратная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Octa Driver [CM]
Octa 3/ Long

REF MOD300L **2023-05-18**

LOT 230518A3211-01

MODEL NAME MOD300L **SN** 001 **rev.01**

Rx Only

Caution **Non-sterile** **Do not use if package is damaged**

Consult instructions for use

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Daejeon-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

CE

Отвертка Octa (Octa Driver) [CM]
Восьмигранник 3/ Длинная

REF MOD300L **2023-05-18**

LOT 230518A3211-01 **ПУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME MOD300L **SN** 001 **rev.01**

Rx Only

Caution **Non-sterile** **Do not use if package is damaged**

Consult instructions for use

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Temperature limitation

15°C 30°C

Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)

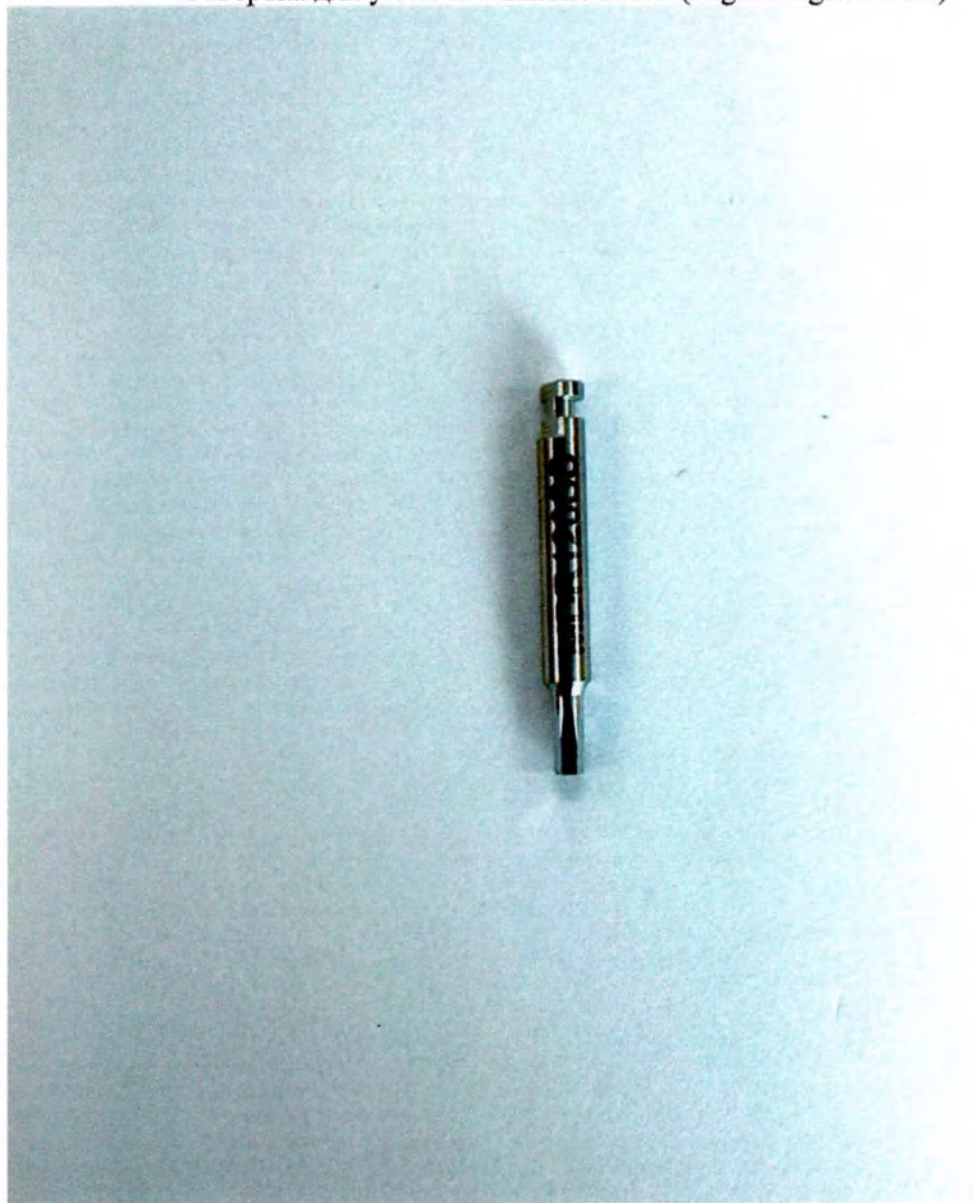

Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)
(индивидуальная упаковка)



Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Right Angle Driver [CM]
Hex 1.2/ Ultra

REF MDR120SS **2023-05-18**

LOT 230518A3272-01

MODEL-NAME MDR120SS **SN** 001

Rx Only

rev.02

Caution **Non-sterile** **Do not use if package is damaged**

Consult instructions for use

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Daseo-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

CE

Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver) [CM]
Шестиграннык 1.2/ Ультра

REF MDR120SS **2023-05-18**

LOT 230518A3272-01 **РУ № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL-NAME MDR120SS **SN** 001

Rx Only

rev.02

Осторожно **Не стерильно** **Не использовать при повреждении упаковки**

Обратитесь к инструкции по применению

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41, 30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон

15°C 30°C

Отвертка установочная (Insert Driver)



Отвертка установочная (Insert Driver) (
индивидуальная упаковка)




Отвертка установочная (Insert Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)




Отвертка установочная
(Insert Driver) [CM]

Шестигранный 1.2/ Короткая



Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)



Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)
(Потребительская упаковка: лицевая сторона, макет маркировки на русском языке)



CE

Отвертка для установки ретенционного колпачка
(Retentive Cap Insertion Tool)

REF 0851EC

2022-10-20

LOT P2210002276

РУ№ XXXXXX от дд мм гггг



Не стерильно

Rx Only



Хранить вдали от
солнечного света



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повреждении
упаковки



(01)08059224000053

(10)P2210002276

(11)201020

Rhein83 S.R.L., Via Zago, 10/ABC-40128
Bologna, Italy


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)
(Потребительская упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Наименование продукта: Хирургический инструмент для дентальной имплантации
Модель: Отвертка для установки ретенционного колпачка 085IAC
Номер: Смотрите описание
Дата производства: Смотрите описание
Назначение: Инструмент используется во время процедуры дентальной имплантации
Импортер: MEGAGEN IMPLANT CO., LTD
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup, Dalseong-gun, Тэгу, 42921, Республика Корея
Производитель: RHEIN 83 S.r.l
(Италия, Via Eilio Zago, 10 40128, Болонья)
Импортируемый продукт: номер декларации Тэгу, номер получения 13-19
Количество в упаковке: 1 набор
Номер регистрации импортера: 1372
Примечание: домашняя страница (ifu.imagagen.com) предоставляет инструкцию по применению
Медицинское изделие / Изделие многократного использования

Сверло копьевидное (Lance Drill)



Сверло копьевидное (Lance Drill)
(Индивидуальная упаковка, моделей: MGD100L, LD1618S, LD1618M, LD2015)



Сверло копьевидное (Lance Drill)
(Индивидуальная упаковка, моделей: LD1618L, LD2025, LD2030)



Сверло копьевидное (Lance Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Сверло копьевидное
(Lance Drill) [CM]
Ø2/ L=15/ Длинное

REF MGD100L

LOT 230428A4459-01

MGD100L

2023-04-28

РУН ХОООООХ ОУ ДД ММ ГГТТ

SN 020

rev.02

Rx Only



На открытом огне



Осторожно



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не используйте изделие
для других целей



(01)000005300220214
(11)230428
(10)230428A4459-01
(21)020
(240)MGD100L



MDSS GmbH Schillgraben41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Oseong-gu
Daejeon-gu Oseong 30531
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7




Температурный
диапазон

Фреза маркировочная (Marking Drill)



Фреза маркировочная (Marking Drill)
(индивидуальная упаковка)



Фреза маркировочная (Marking Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Marking Drill [AR]
Ø2.0/ L=18.0/ Twist

REF TANTDF2018 **2023-08-29**

LOT 230829A1831-01

MODEL-NAME TANTDF2018 **SN** 005

Rx Only

rev.01

(01)08806388238316
(11)230829
(10)230829A1831-01
(21)005
(240)TANTDF2018

Caution

Non-sterile

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

CE
2460

Фреза маркировочная
(Marking Drill) [AR]
Ø2.0/ L=18.0/ Закрученная

REF TANTDF2018 **2023-08-29**

LOT 230829A1831-01 **ПУН № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL-NAME TANTDF2018 **SN** 005

Rx Only

rev.01

(01)08806388238316
(11)230829
(10)230829A1831-01
(21)005
(240)TANTDF2018

Caution

Non-sterile

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany


MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Температурный диапазон

15°C 30°C

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д. 18, пом. III, ком. 7

Фреза формирующая (Shaping Drill)



Фреза формирующая (Shaping Drill)
(Индивидуальная упаковка, моделей: SD2818S, SD2518M, SD2518S, SD2818M)



Фреза формирующая (Shaping Drill)
(Индивидуальная упаковка, моделей: SD2518L, SD2818L)



Фреза формирующая (Shaping Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Фреза формирующая
(Shaping Drill) [CM]
Ø2.8/ L=18/ Среднее

REF SD2818M

LOT 210831A0540-01

MODEL SD2818M

2023-04-28

РУН ХХХХХХХХ от дд.мм.гггг

SN 008

rev.00



Не стерильно



Осторожно



Обратитесь к
инструкции по
применению



Не использовать
при повторном
употреблении

Rx Only



(01)09806398234630
(11)210831
(10)230428A4459-01
(21)008
(240)SD2818M



MDSS GmbH Schillgraben 41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
46 Secheon-ro 7gil Daejeon-si
Daejeong-gu 42821
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125134, г. Москва,
ул. 3-я Рыжого поля, д. 16, пом. 18, пом. 7



Температурный
диапазон

Фреза со стоппером (Stopper Drill)



Фреза со стопером (Stopper Drill)
(индивидуальная упаковка)



Фреза со стоппером (Stopper Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Stopper Drill [AR]
Ø2/ L=10/ Twist

REF TANTDF2010  2023-05-23

LOT 230523A2911-01

MODEL NAME TANTDF2010 **SN** 001

Rx Only

 Caution

 Non-sterile

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

rev.01

(01)08806388238293
(11)230523
(10)230523A2911-01
(21)001
(240)TANTDF2010

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460

Фреза со стоппером (Stopper Drill) [AR]
Ø2/ L=10/ Закрученная

REF TANTDF2010  2023-05-23

LOT 230523A2911-01

MODEL NAME TANTDF2010 **SN** 001

Rx Only

 Осторожно

 Не стерильно

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

rev.01


(01)08806388238293
(11)230523
(10)230523A2911-01
(21)001
(240)TANTDF2010

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

 15°C 30°C
Температурный диапазон

Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)

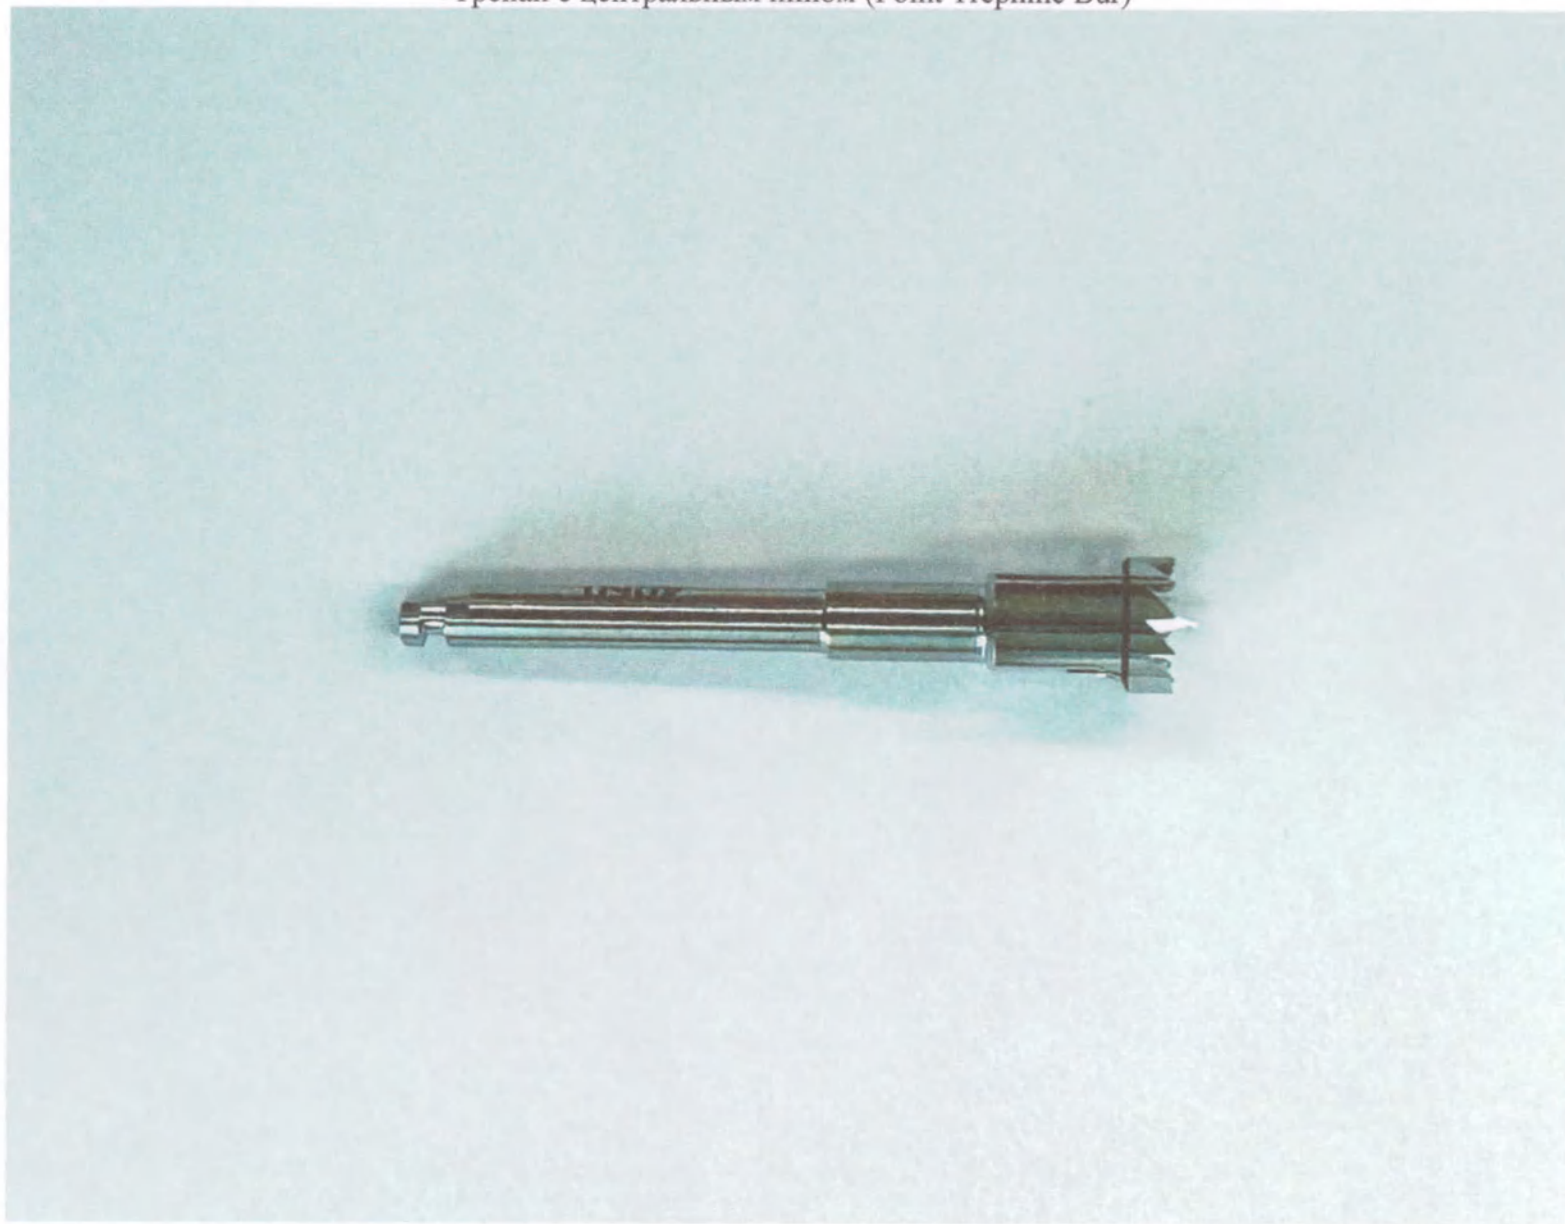

Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)
(индивидуальная упаковка)



Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)


2460
Point Trephine Bur [CM]
Ø4/ Ø5

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

REF SPTB4050
LOT 220614A0394-01
MODEL NAME SPTB4050

 2022-06-14
SN 023 rev 04



 Caution


 Non-sterile


 Consult
Instructions
for use


 Do not use
if package
is damaged

Rx Only
 (01)08806388236572
 (11)220614
 (10)220614A0394-01
 (21)023
 (240)SPTB4050

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

 MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 15°C — 30°C
 Temperature
limitation


2460
Трепан с центральным пином
(Point Trephine Bur) [CM]
Ø4/ Ø5

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

REF SPTB4050
LOT 220614A0394-01
MODEL NAME SPTB4050

 2022-06-14
SN 023 rev.04



 Осторожно


 Не стерильно


 Не использовать
при повреждении
упаковки


 Обратитесь к
инструкции по
применению


 Не использовать
при повреждении
упаковки

Rx Only
 (01)08806388236572
 (11)220614
 (10)220614A0394-01
 (21)023
 (240)SPTB4050


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

 MegaGen Implant Co. Ltd.
 45 Secheon-ro 7-gil Dasa-eup
 Dalseong-gun Daegu 42921
 Republic of Korea


 15°C — 30°C
 Температурный
диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
 ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)

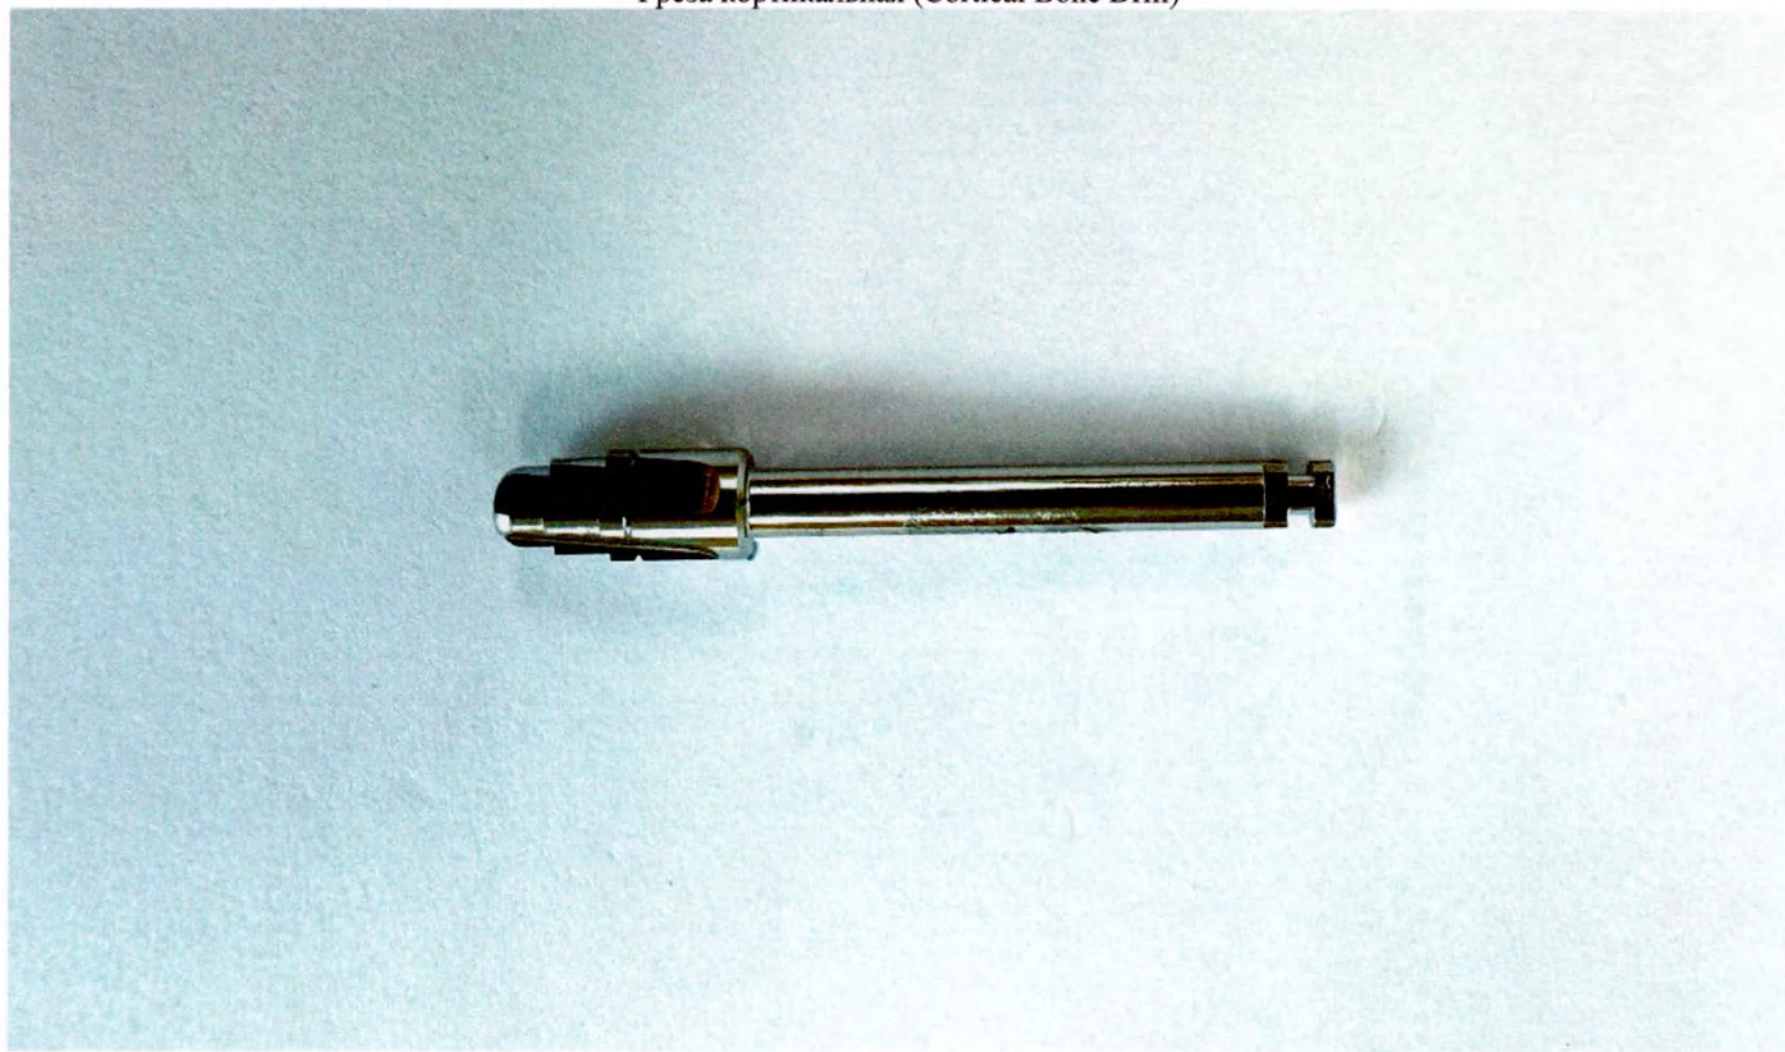

Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)
(индивидуальная упаковка)



Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460
Cortical Bone Drill [AR]
Ø4/ L=9

REF TANCDL3500  2022-06-21

LOT 220621A0330-01

MODEL NAME TANCDL3500 **SN** 005 rev 00

Rx Only 

(01)08806388237111
(11)220621
(10)220621A0330-01
(21)005
(240)TANCDL3500

 Caution  Non-sterile

 Consult Instructions for use  Do not use if package is damaged

EC REF MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
38552 Republic of Korea

 15°C 30°C
Temperature limitation

CE
2460
Фреза кортикальная
(Cortical Bone Drill) [AR]
Ø4/ L=9

REF TANCDL3500  2022-06-21

LOT 220621A0330-01 **ПУН** XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME TANCDL3500 **SN** 005 rev.01

Rx Only 

(01)08806388237111
(11)220621
(10)220621A0330-01
(21)005
(240)TANCDL3500

 Осторожно  Не стерильно


 Обратитесь к инструкции по применению  Не использовать при повреждении упаковки

EC REF MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

 15°C 30°C
Температурный диапазон

Бур трепанационный (Trephine Bur)



Бур трепанационный (Trephine Bur)
(индивидуальная упаковка)



Бур трепанационный (Trephine Bur)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Trephine Bur [CM]
Ø4.1/Ø4.7

REF TANTBL4147
LOT 230518A3220-01
MODEL NAME TANTBL4147

2023-05-18

SN 001

rev.00

Rx Only

Caution

Non-sterile

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08809854026950
(11)230518
(10)230518A3220-01
(21)001
(240)TANTBL4147

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation

CE
2460

Бур трепанационный
(Trephine Bur) [CM]
Ø4.1/Ø4.7

REF TANTBL4147
LOT 230518A3220-01
MODEL NAME TANTBL4147

2022-06-14
РУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

SN 001

rev.04

Rx Only

Caution

Non-sterile

Не стерильно

Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)0880638826950
(11)230518
(10)230518A3220-01
(21)001
(240)TANTBL4147

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Temperature limitation

Профилировщик кости (Bone Profiler),
Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin)



Профилировщик кости (Bone Profiler)
Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin) (индивидуальная упаковка)



Профилировщик кости (Bone Profiler)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE 2460

Профилировщик кости
(Bone Profiler) [AR]
Ø4/ Длинный

REF TANBPL40G

LOT 230823A3620-01

MODEL-NAME TANBPL40

2023-08-23

РУ № XXXXXX от дд мм гггг

SN 002

rev.00

Rx Only

Caution
Осторожно

Non-sterile
Не стерильно

Do not use if package is damaged
Не использовать при повреждении упаковки


(01)08806388237074
(11)230823
(10)230823A3620-01
(21)002
(240)TANBPL40G

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7

Temperature limitation
Температурный диапазон


Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)



Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)
(индивидуальная упаковка)



Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



CE 2460

**Сверло Линдемманна
(Lindermann Drill) [CM]**
Ø2/ L=15

REF TEEL200M

LOT 230523A0141-01

MODEL NAME TEEL200M


2023-04-28

ПУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ


SN 001

rev.02

Rx Only



Не стерильно



(01)08806388239573
(11)230523
(10)230523A0141-01
(21)001
(240)TEEL200M


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7



Фреза выравнивающая (Flattening Drill)

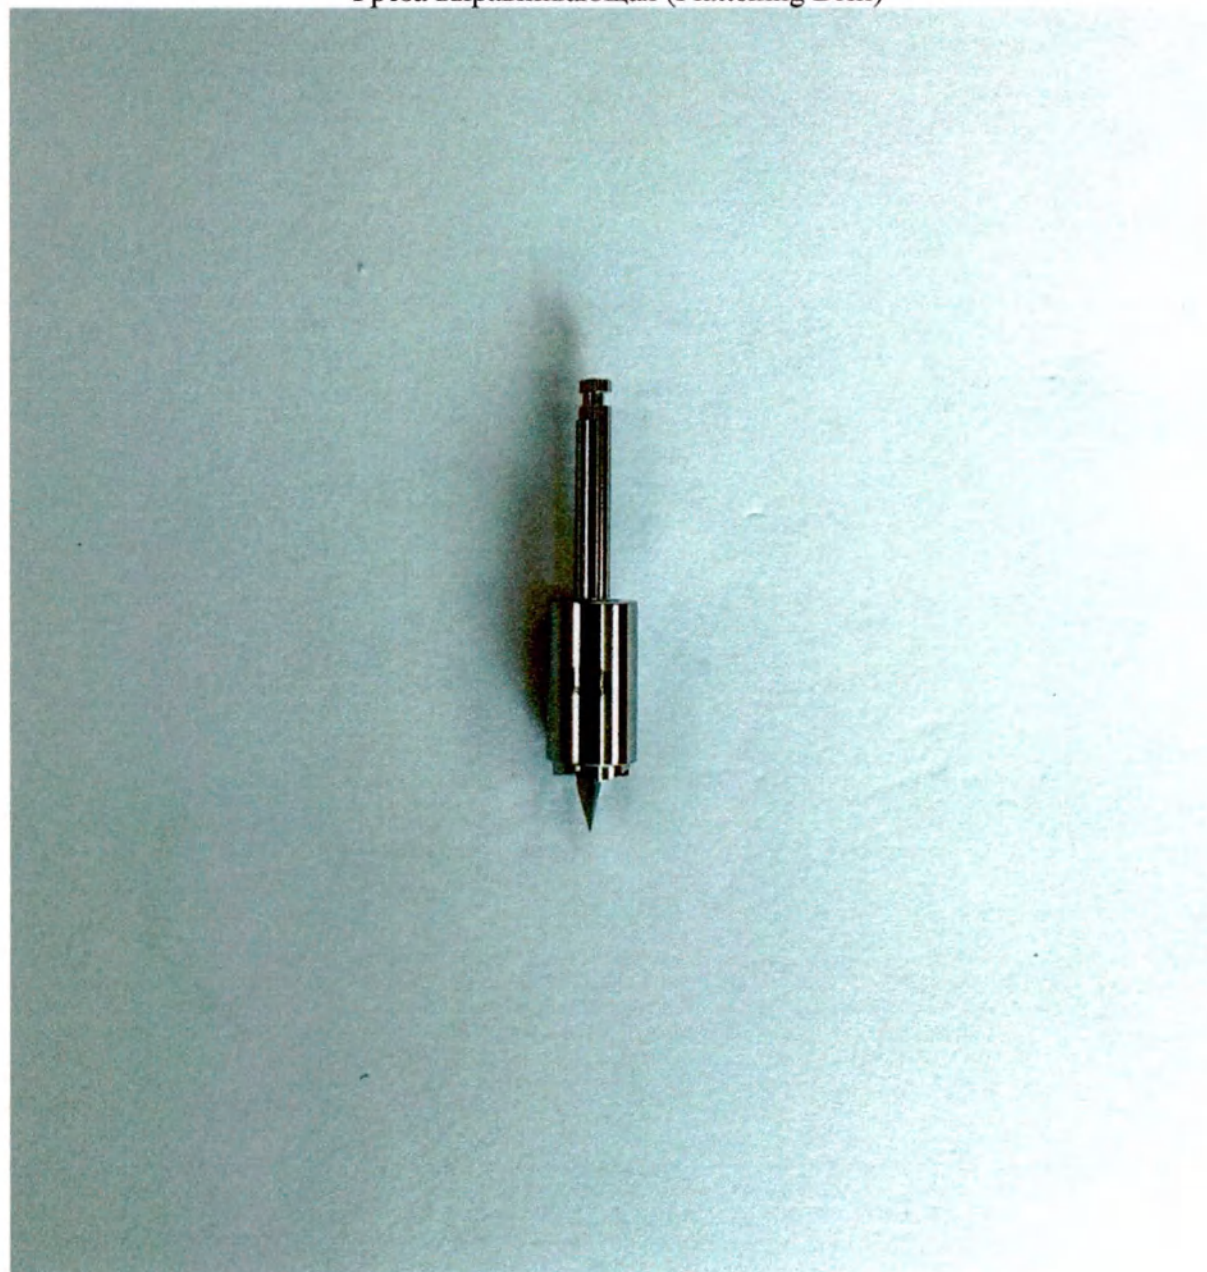

Фреза выравнивающая (Flattening Drill)
(индивидуальная упаковка)



Фреза выравнивающая (Flattening Drill)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Flattening Drill [CM]
Ø5/ Ø2/ L=3.5

REF FD5020

LOT 230512A3800-01

MODEL NAME FD5020

SN 002

rev.00

Rx Only

Caution

Non-sterile

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

(01)08806388244232
(11)230512
(10)230512A3800-01
(21)002
(240)FD5020

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

CE
2460

Фреза выравнивающая
(Flattening Drill) [CM]
Ø5/ Ø2/ L=3.5

REF FD5020

LOT 230512A3800-01

MODEL NAME FD5020

SN 002

rev.00

Rx Only

Осторожно

Не стерильно

Обратитесь к инструкции по применению

Не использовать при повреждении упаковки

(01)08806388244232
(11)230512
(10)230512A3800-01
(21)002
(240)FD5020


EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


Температурный диапазон

15°C 30°C

Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)



Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)
(индивидуальная упаковка)



Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE 2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Tissue Punch [CM]
Ø3/ L=14

REF TCMTPM0304  2023-06-19

LOT 230619A3870-01

MODEL NAME TCMTPM0304 **SN** 032

Rx Only

 Caution

 Non-sterile

 Consult instructions for use


 Do not use if package is damaged

 rev.00

(01)08806388238842
(11)230619
(10)230619A3870-01
(21)032
(240)TCMTPM0304

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 Temperature limitation

CE 2460

Перфоратор слизистой оболочки
(Tissue Punch) [CM]
Ø3/ L=14

REF TCMTPM0304  2023-06-16

LOT 230616A3870-01 **ПУН** XXXXXX от дд мм гггг

MODEL NAME TCMTPM0304 **SN** 032

Rx Only

 Осторожно

 Не стерильно

 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки

 rev.00


(01)08806388238842
(11)230616
(10)230616A3870-01
(21)032
(240)TCMTPM0304

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

 Температурный диапазон

Триммер лунки (Hole Trimmer)

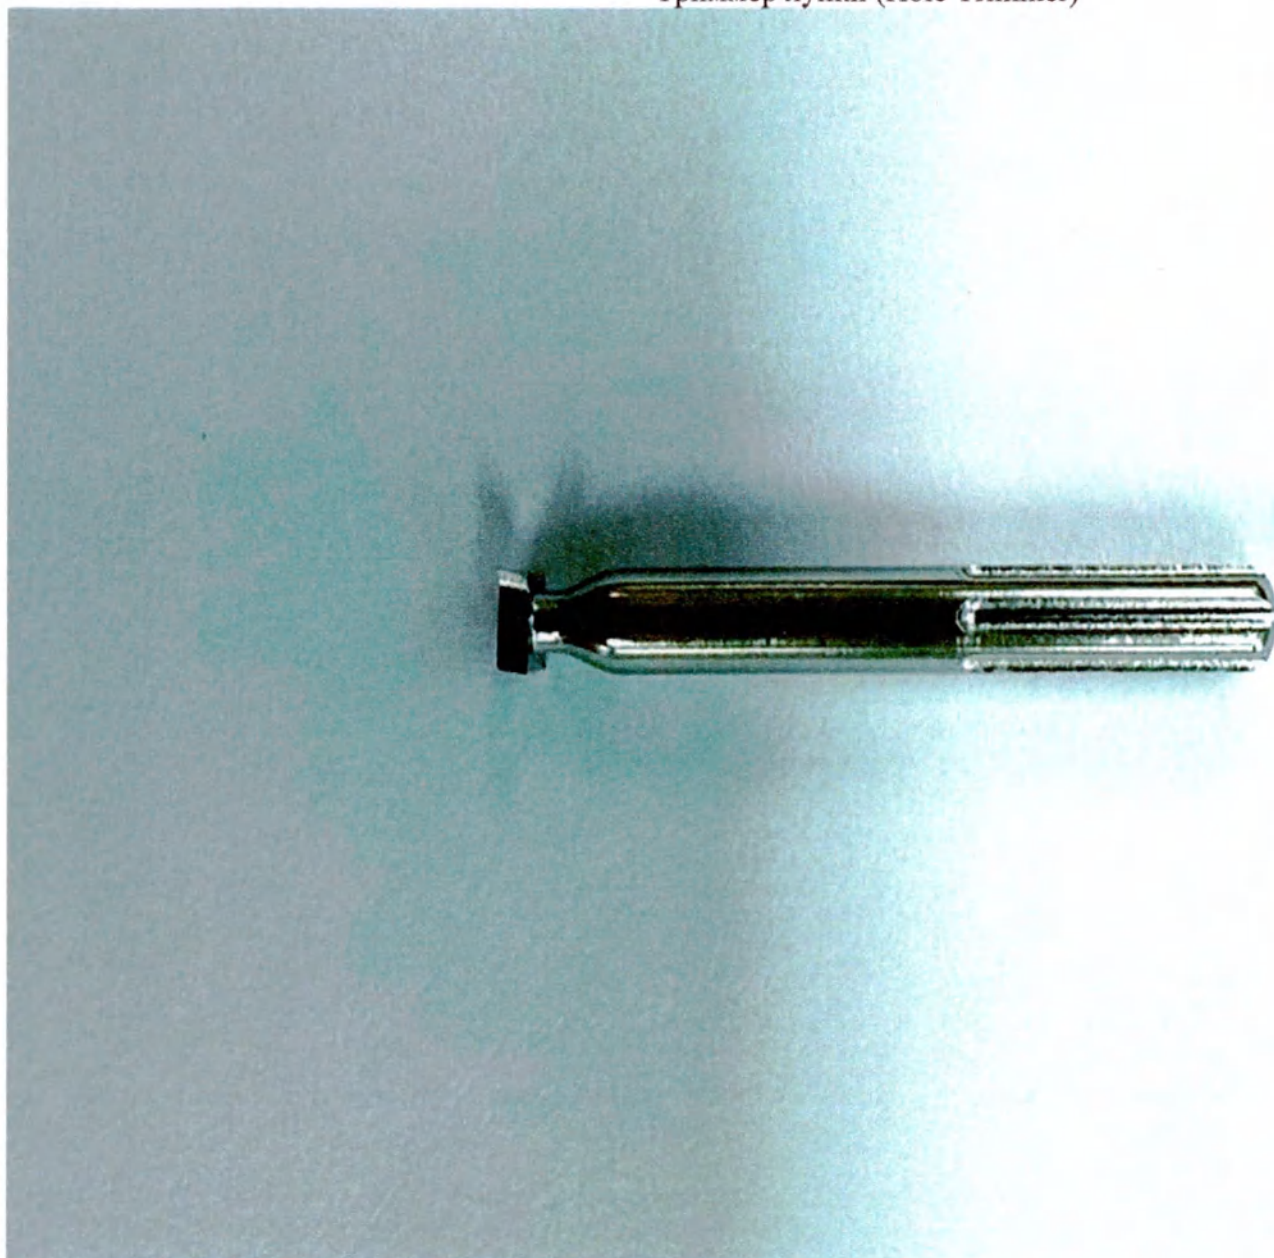

Триммер лунки (Hole Trimmer)
(Индивидуальная упаковка, моделей: AGHTN2, AGHTR2, AGHTW2)






For Lifetime Smiles


Hole Trimmer [CM]
Narrow/ Stopper Hole

REF AGHTN2

LOT 230720A3190-01

MODE-NAME AGHTN2

 2023-07-20

SN 013

 **Caution**

 **Non-sterile**

 **Consult instructions for use**

Rx Only

 **Do not use if package is damaged**


rev.00



(01)08806388241842
(11)230720
(10)230720A3190-01
(21)013
(240)AGHTN2

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41,
30175 Hannover, Germany

 MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gill, Dasa-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

 **Temperature limitation**
15°C — 30°C

Триммер лунки (Hole Trimmer)
(Индивидуальная упаковка, моделей: AGHTN3, AGHTR3, AGHTW)



Триммер лунки (Hole Trimmer)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Триммер лунки (Hole Trimmer) [CM]
Узкий/ со стоппером

REF AGHTN2

LOT 230720A3190-01

MODEL NAME AGHTN2

2023-07-20

РУН XXXXXX от дд мм гггг

SN 013

rev.00

Rx Only



(01)08806388238293
(11)230720
(10)230720A3190-01
(21)013
(240)AGHTN2


EC REP

MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7



Фреза Auto-Max (Auto-Max)

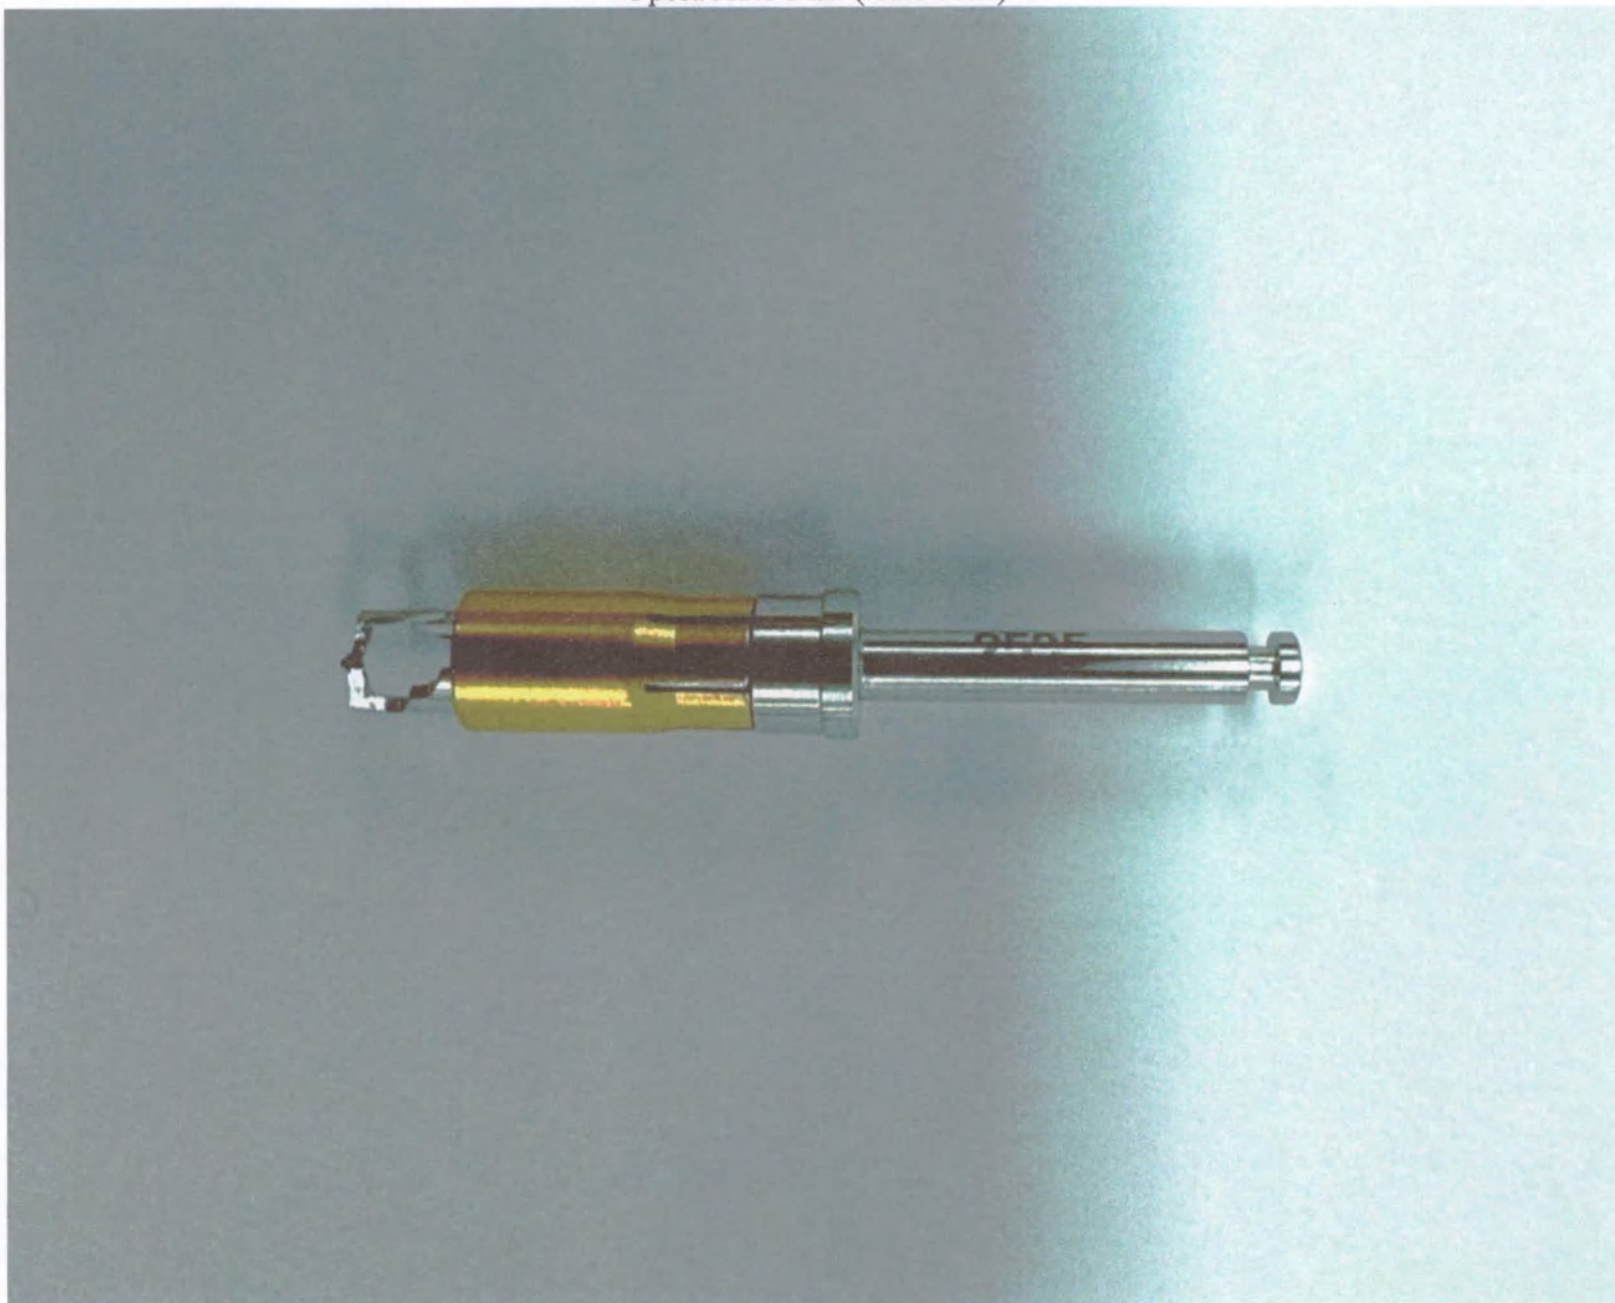

Фреза Auto-Max (Auto-Max)
(индивидуальная упаковка)



Фреза Auto-Max (Auto-Max)
(Индивидуальная упаковка: обратная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE
2460

For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Auto-Max [CM]
Ø2.5 ~ Ø3.5 / Stopper

REF AM2535  2023-09-06

LOT 230906A2550-01

MODEL NAME AM2535 **SN** 001 **rev.00**

Rx Only

 Caution

 Non-sterile


 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

(01)08806388206711
(11)230906
(10)230906A2550-01
(21)001
(240)AM2535

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

 15 °C 30 °C
Temperature limitation

CE
2460

Фреза Auto-Max (Auto-Max) [CM]
Ø2.5 - Ø3.5/ со стоппером

REF AM2535  2023-09-06

LOT 230906A2550-01 **ПУН № XXXXXX от дд мм гггг**

MODEL NAME AM2535 **SN** 001 **rev.00**

Rx Only

 Осторожно

 Не стерильно


 Обратитесь к инструкции по применению

 Не использовать при повреждении упаковки


(01)08806388206711
(11)230906
(10)230906A2550-01
(21)001
(240)AM2535

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

 15 °C 30 °C
Температурный диапазон

Имплантовод машинный (Handpiece Connector)

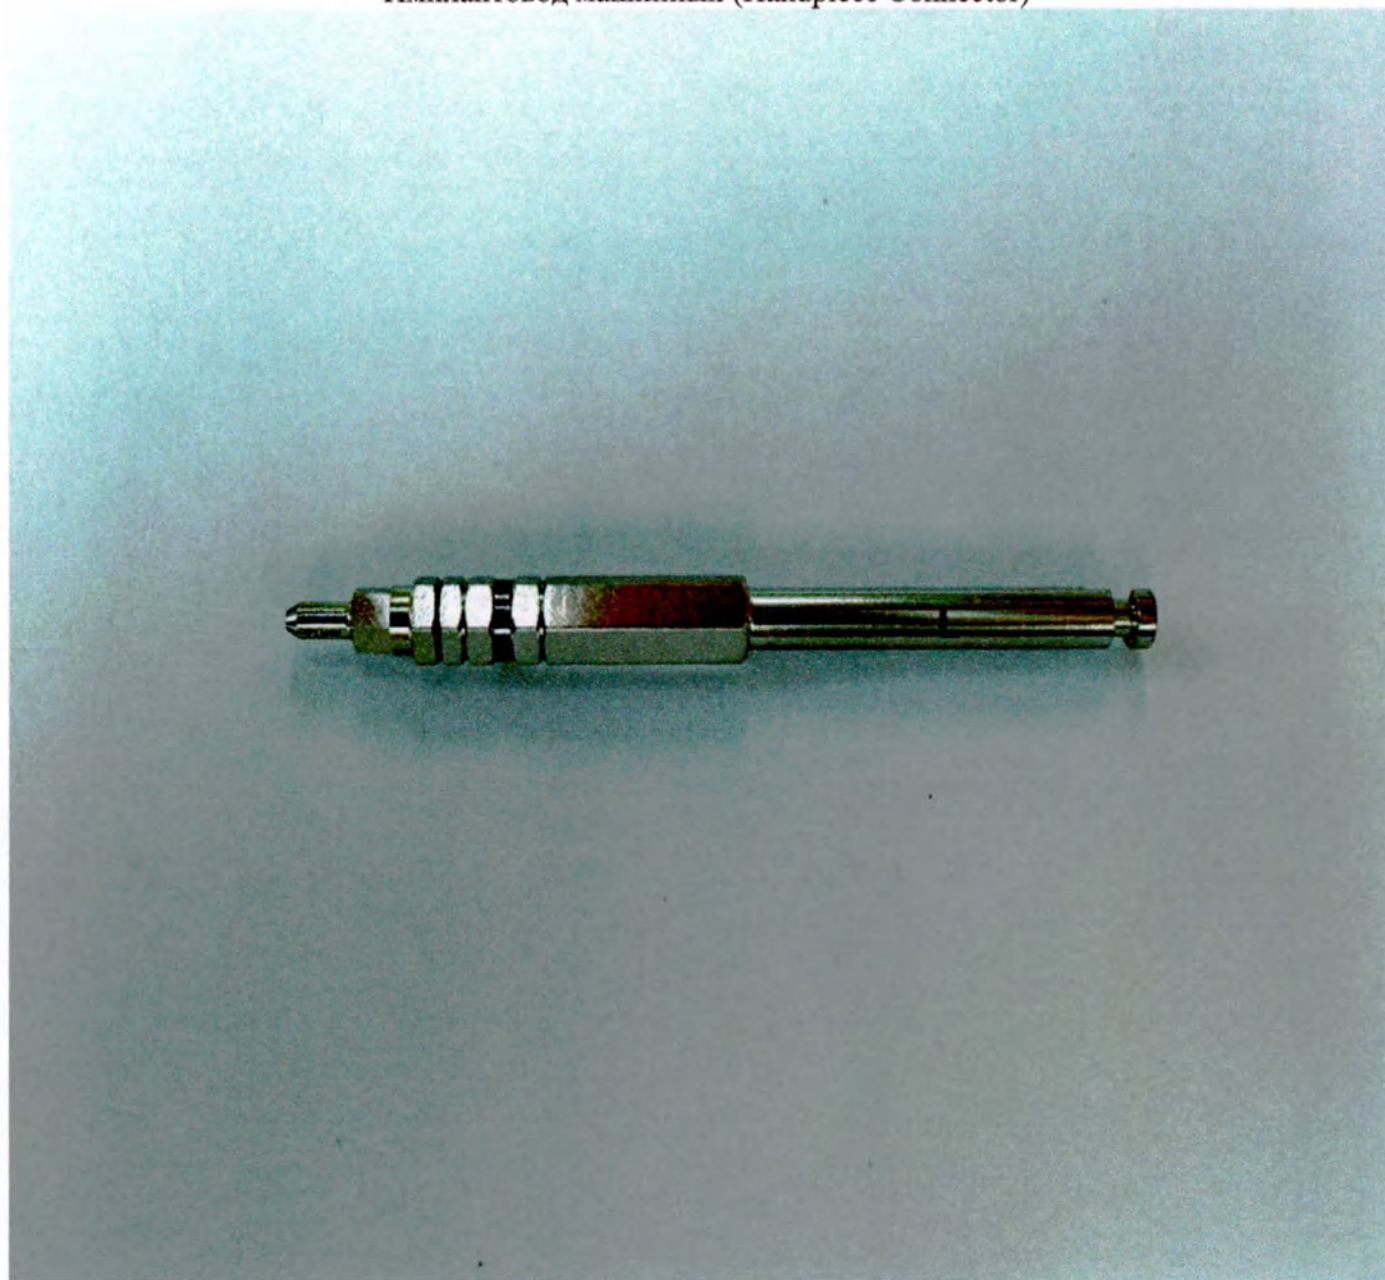

Имплантовод машинный (Handpiece Connector)
(индивидуальная упаковка)



Имплантовод машинный (Handpiece Connector)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)

CE **MD** For Lifetime Smiles **MEGA'GEN**

Handpiece Connector [AR]
Long

REF TANHCL **2023-05-22**

LOT 230522A2724-01

MODEL NAME TANHCL **SN** 001 **rev.04**

Rx Only

Caution **Non-sterile** **Consult instructions for use** **Do not use if package is damaged**

EC REP MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7gil, Daseo-eup,
Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea

Temperature limitation

15°C 30°C

CE **MD**

Имплантовод машинный
(Handpiece Connector) [AR]
Длинный

REF TANHCL **2023-05-22**

LOT 230522A2724-01 **ПУ № XXXXXX от ДД ММ ГГГГ**

MODEL NAME TANHCL **SN** 001 **rev.04**

Rx Only

Осторожно **Не стерильно** **Обратитесь к инструкции по применению** **Не использовать при повреждении упаковки**

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben 41, 30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Температурный диапазон

15°C 30°C

Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)



Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)
(индивидуальная упаковка)



Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)





Ratchet Connector [AR]
Short

REF TANRES

LOT 230322A5364-01

MODEL NAME TANRES

 2023-03-22

SN 001

rev.04



(01)08806388237852
(11)230322
(10)230322A5364-01
(21)001
(240)TANRES



Caution


Non-sterile


Consult instructions for use


Do not use if package is damaged

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany


Temperature limitation

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea



**Имплантовод для храпового ключа
(Ratchet Connector) [AR]**
Короткий

REF TANRES

LOT 230322A5364-01

MODEL NAME TANRES

 2023-03-22

SN 001

rev.04



(01)08806388237852
(11)230322
(10)230322A5364-01
(21)001
(240)TANRES



Осторожно


Не стерильно


Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea


Температурный диапазон

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком. 7

Удлинитель фрез (Drill Extension)

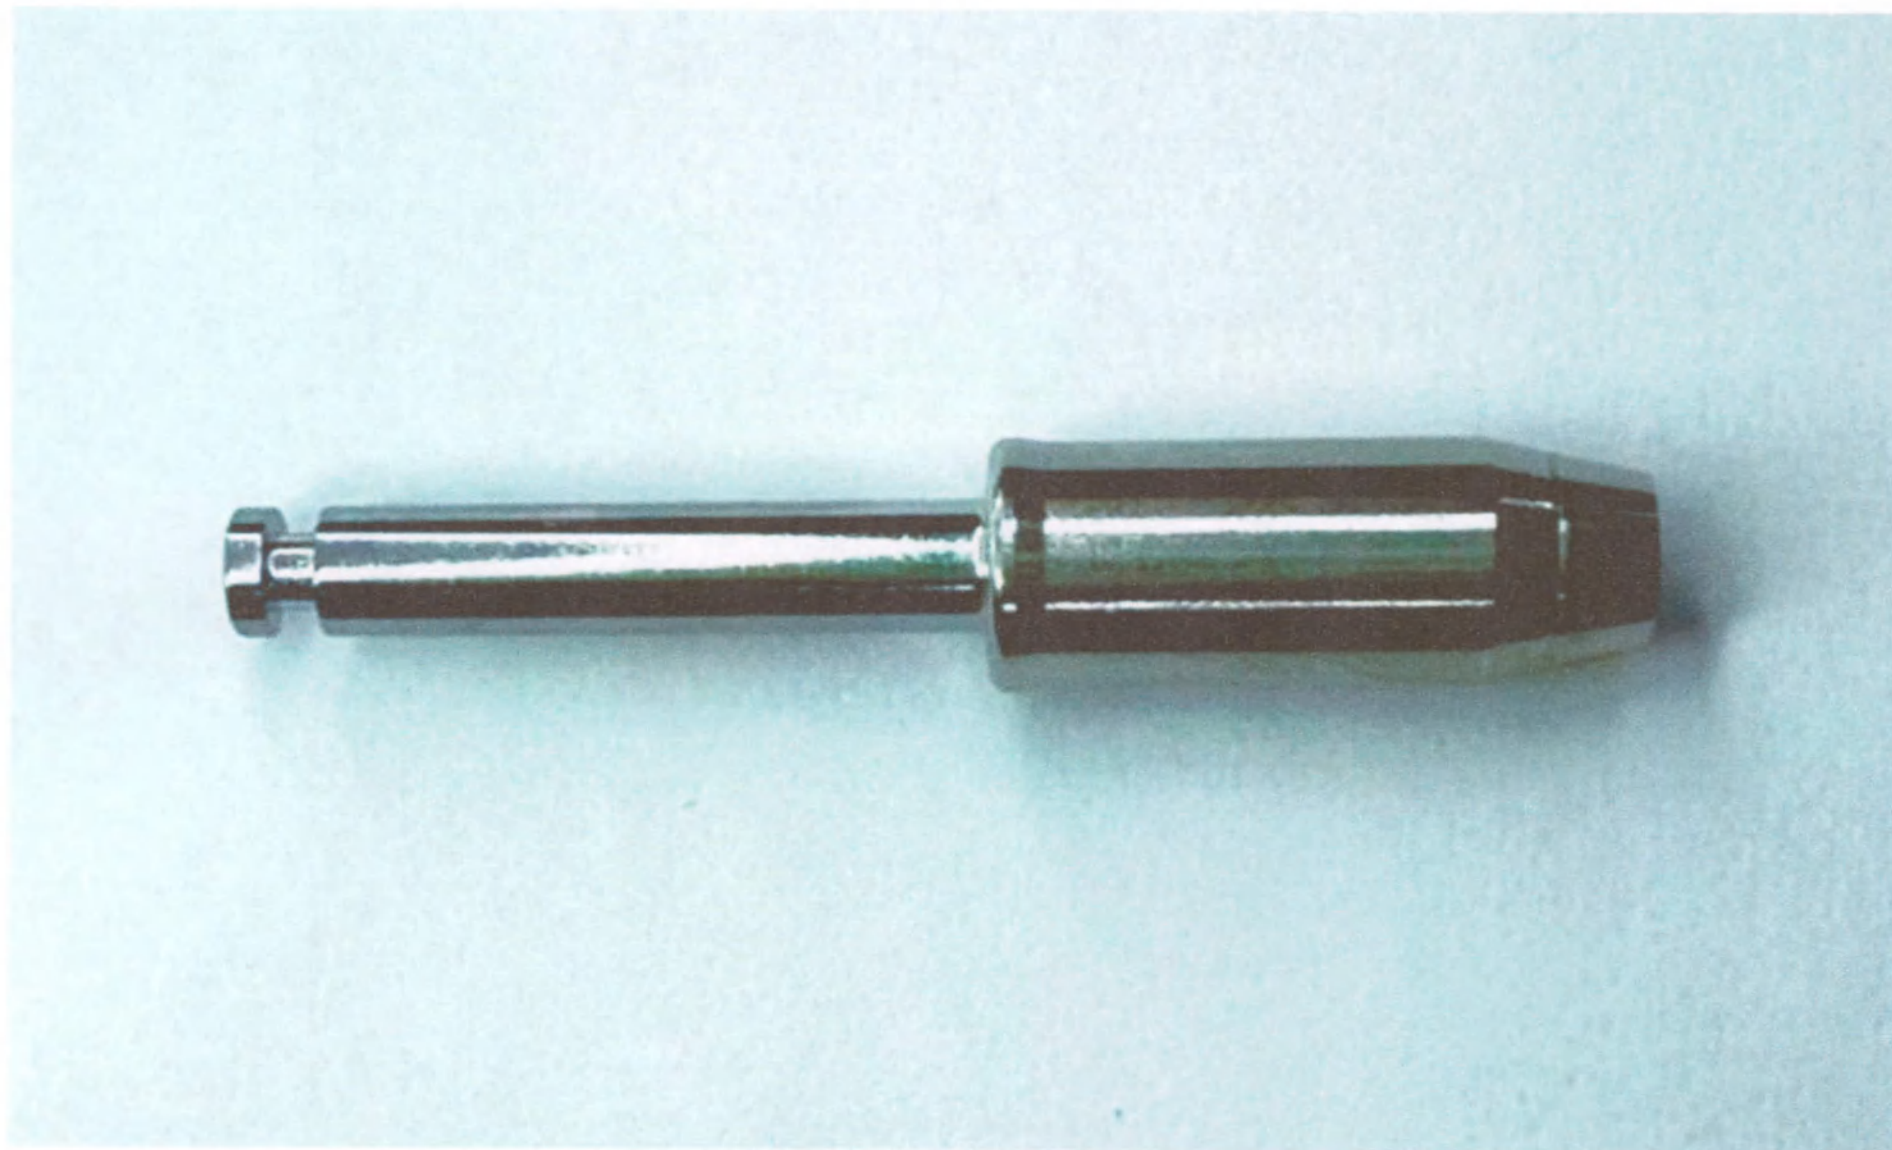


Удлинитель фрез (Drill Extension)
(индивидуальная упаковка)



Удлинитель фрез (Drill Extension)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Пин параллельности (Directon Indicator)



Пин параллельности (Directon Indicator)
(индивидуальная упаковка)



Пин параллельности (Directon Indicator)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Пин параллельности
(Directon Indicator) [CM]
Ø2-Ø2.8

REF MDI100

2023-04-24

LOT 230424A0311-01

ПУН № XXXXXX от дд мм гтт

MODEL NAME MDI100

SN 019

rev.01




Rx Only

EC REP MDSS GmbH Schiffgraben41
30175 Hannover Germany
MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля., д. 18, пом. III, ком. 7



Ключ динамометрический (Torque Wrench),
Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)

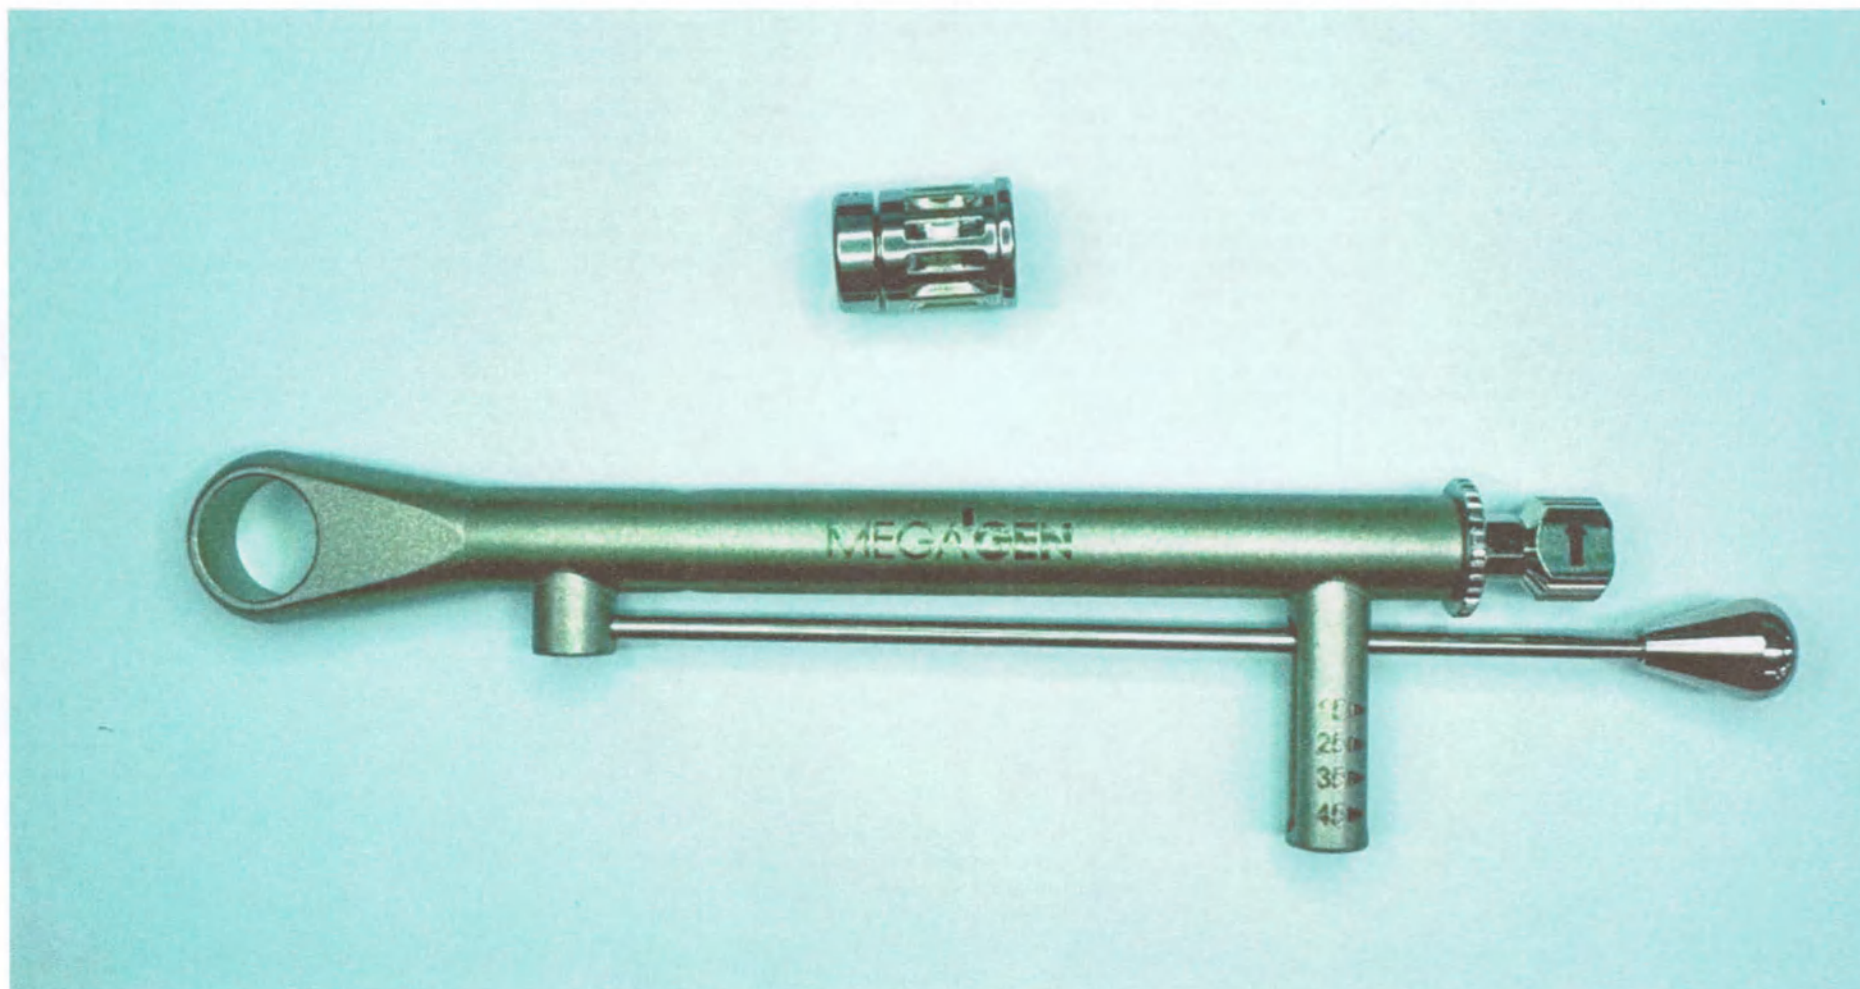

Ключ динамометрический (Torque Wrench),
Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter) (индивидуальная упаковка)



Ключ динамометрический (Torque Wrench)
(Индивидуальная упаковка: макет маркировки на русском языке)



Ключ динамометрический
(Torque Wrench) [CM]

REF MTW300AT

2023-05-04

LOT 230504A3811-01

РУМ ХХХХХХ СТ АД ММ ППТ

MODEL NAME MTW300A

SN 001

rev.01



Не стараться

Rx Only



Осторожно



Обратиться к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки



(01)08806388229321
(11)230504
(10)230504A3811-01
(21)001
(240)MTW300AT



MDSS GmbH Schallgraben 41
30175 Hannover Germany



MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Daejeon-si
Daejeong-gun Daejeon 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7



Температурный диапазон

Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)



Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)
(индивидуальная упаковка)




Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)




Адаптер для динамометрического ключа
(Torque Wrench Adapter) [CM]

Тип трещетки



Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)

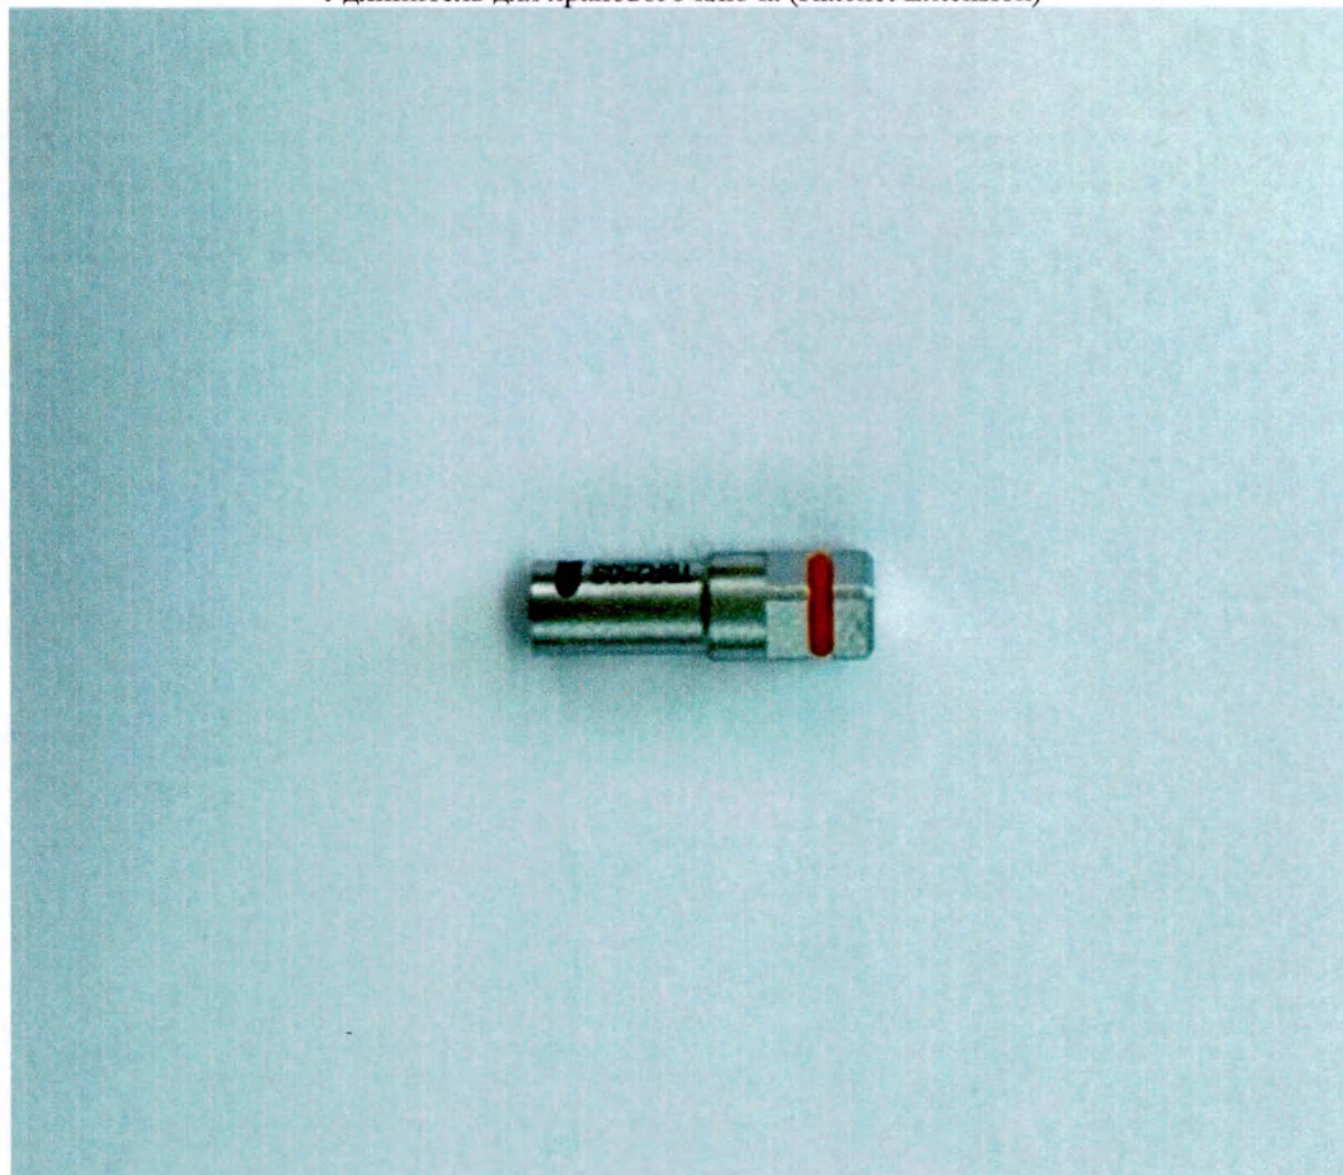


Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)
(индивидуальная упаковка)



Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



Удлинитель для храпового ключа
(Ratchet Extension)
Шестигранный 2.5/ Короткий/ Шаровидный



Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)



Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)
(индивидуальная упаковка)




Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)




Отвертка для ключа динамометрического
(Torque Driver) [CM]
Шестигранник 2.5/ Короткая




Втулка шаблона (Stent Sleeve)



Втулка шаблона (Stent Sleeve)
(индивидуальная упаковка)

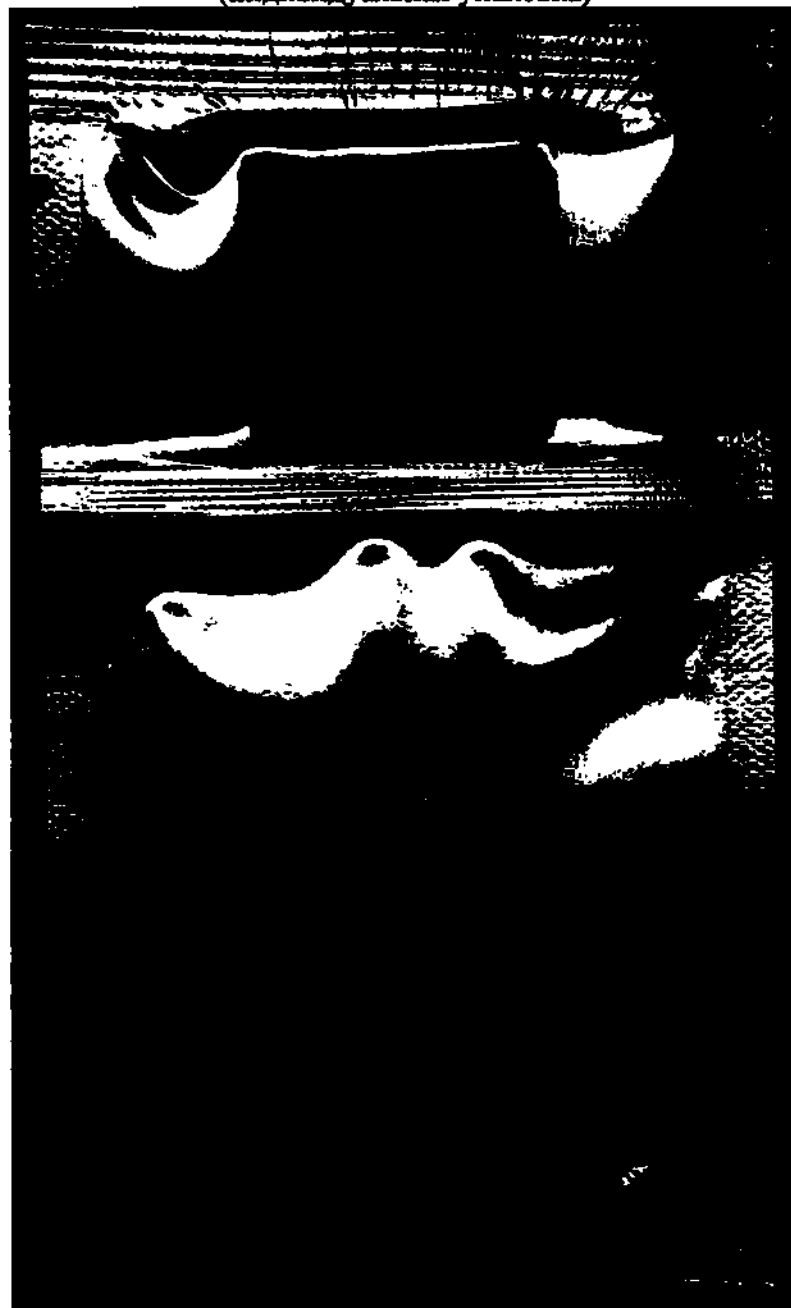

Втулка шаблона (Stent Sleeve)
(Индивидуальная упаковка: оборотная сторона, макет маркировки на русском языке)



ПРОШито , пронумеровано
и скреплено печатью
309 лист 16

