

Фотографические изображения изделия
Программное обеспечение
«Система центрального мониторинга
Registratura Central Station 4.0»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Накопитель с программным обеспечением.....	3
2. Персональный компьютер сервера до 16 пациентов (А).....	4
Персональный компьютер сервера до 32 пациентов (Б).....	4
3. Персональный компьютер станции до 16 пациентов (А), Персональный компьютер станции до 32 пациентов (Б).....	5
4. Ноутбук.....	6
5. Монитор станции до 16 пациентов.....	7
6. Монитор станции до 32 пациентов.....	8
7. Неуправляемый коммутатор.....	9
8. Управляемый коммутатор.....	10
9. Маршрутизатор.....	11
10. Регистратор.....	12
11. Блок розеток.....	13
12. Динамики.....	14
13. Клавиатура.....	15
14. Мышь.....	16
15. Принтер.....	17
16. Кабели сетевые.....	18
17. Видеокабели.....	19
18. Кабели питания.....	20
19. Разветвитель видеосигнала.....	21
20. Удлинитель видеокабеля.....	22
21. Шкаф коммутационный.....	23
22. Коммутационная панель.....	24
23. ИБП в шкаф коммутационный.....	25
24. ИБП.....	26
25. Электронный ключ защиты.....	27
26. Паспорт.....	28
27. Руководство по эксплуатации.....	29
28. Коробка и ее маркировка.....	30
29. Упаковка транспортная и ее маркировка.....	31
30. Интерфейс станции до 16 пациентов (окно авторизации).....	32
31. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Общий мониторинг»).....	33
32. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Индивидуальный мониторинг»).....	34
33. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Оборудование»).....	35
34. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Отделение»).....	36
35. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Настройки»).....	37
37. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Справка»).....	39
38. Интерфейс станции до 32 пациентов (окно авторизации).....	40
39. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Общий мониторинг»).....	41
40. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Индивидуальный мониторинг»).....	42
41. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Оборудование»).....	43
42. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Отделение»).....	44
43. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Настройки»).....	45
44. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Архив»).....	46
45. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Справка»).....	47



1. Накопитель с программным обеспечением



А



Б

**2. Персональный компьютер сервера до 16 пациентов (А),
Персональный компьютер сервера до 32 пациентов (Б)**



A



Б

**3. Персональный компьютер станции до 16 пациентов (А),
Персональный компьютер станции до 32 пациентов (Б)**



4. Ноутбук




5. Монитор станции до 16 пациентов




6. Монитор станции до 32 пациентов




7. Неуправляемый коммутатор

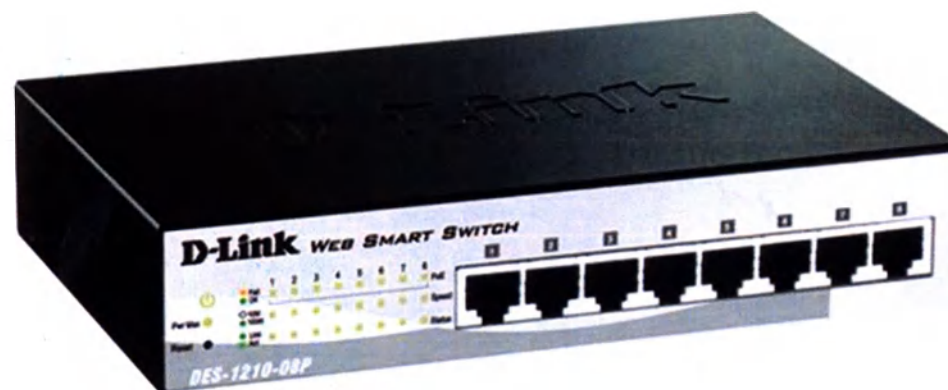

8. Управляемый коммутатор

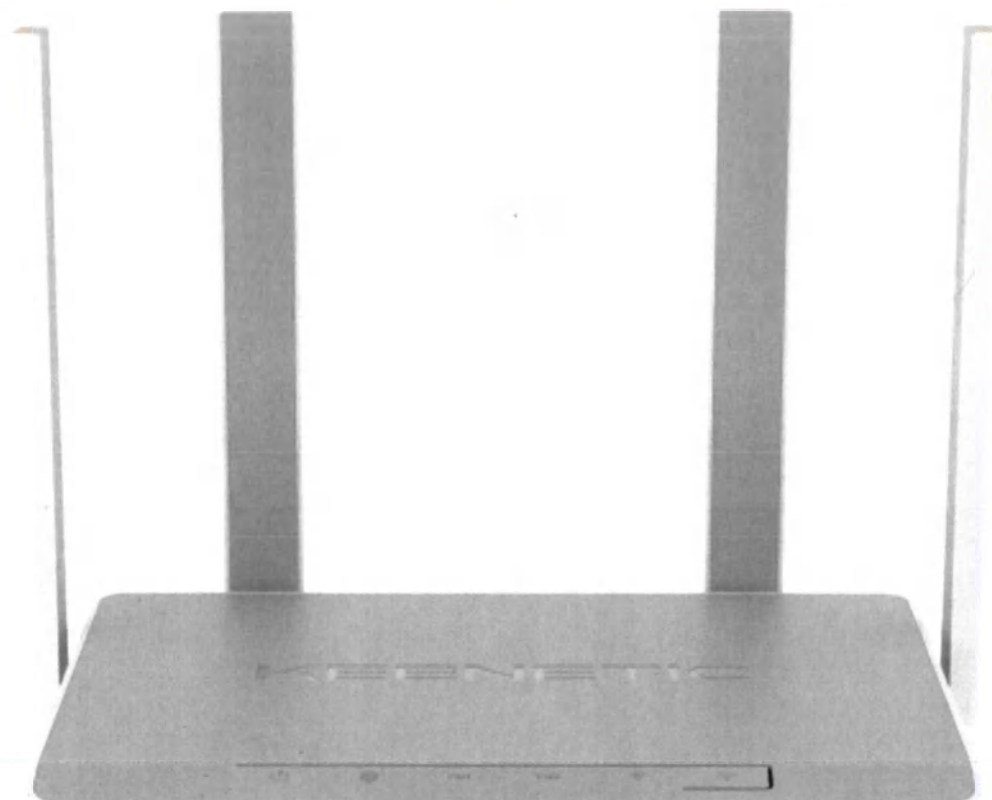

9. Маршрутизатор

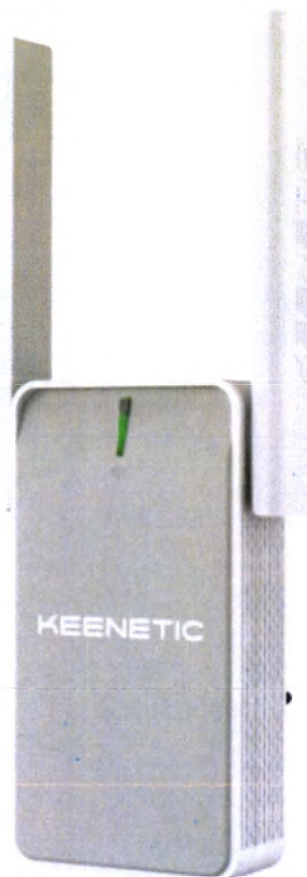

10. Ретранслятор



12. Динамики



13. Клавиатура



14. Мышь

15. Принтер






16. Кабели сетевые



17. Видеокабели

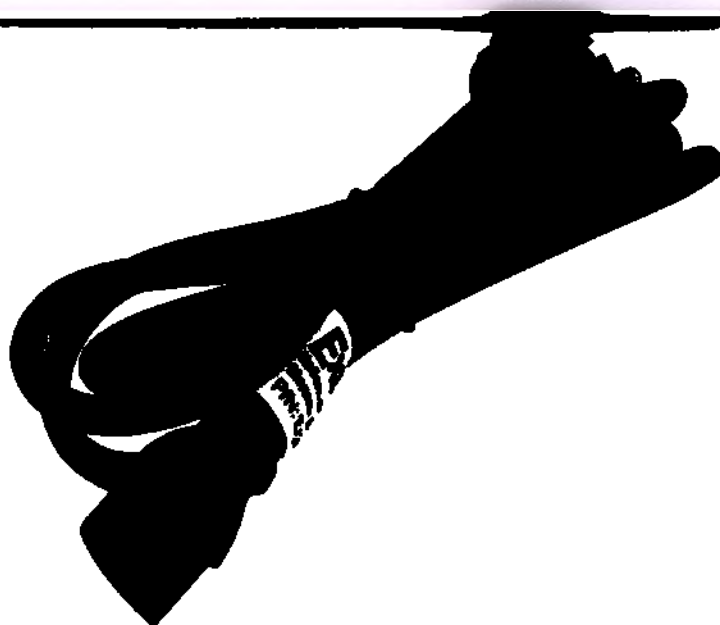

18. Кабели питания




19. Разветвитель видеосигнала



20. Удлинитель видеосигнала



21. Шкаф коммутационный

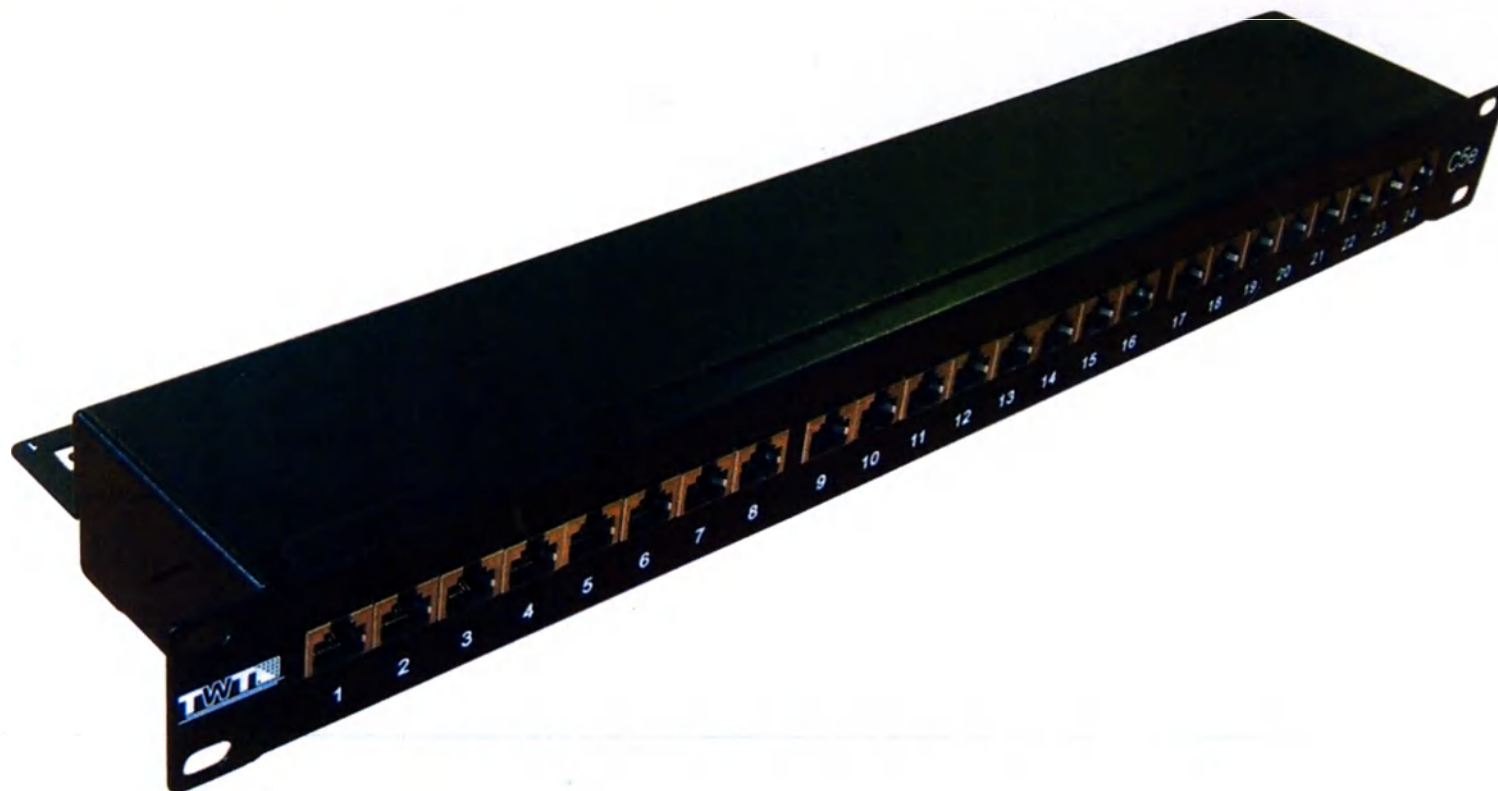

22. Коммутационная панель



23. ИБП в шкаф коммутационный



24. ИБП



25. Электронный ключ защиты

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
REGISTRATURA CENTRAL STATION 4.0»**

Паспорт

ТЕСН.941119.004 ПС



26. Паспорт

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
REGISTRATURA CENTRAL STATION 4.0»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕСН.941119.004 Р 1**

27. Руководство по эксплуатации



SN	
РУ	
№	

Производитель: ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

Программный (датированный)

Сервисный центр авторизованной поддержки

REGISTRATURA
Central
Station A Q

Treaton

REGISTRATURA

TECH 041119 004 TV

Координатный адрес:	Россия, 620027, Екатеринбург, Шаверкина, 9-217
Адрес места производства:	Россия, 620133, Екатеринбург, Бажова, 33
Сервисная служба:	+7 (343) 304-60-52 +7 (800) 500-80-53
Служба качества:	+7 (343) 304-60-50
Почтовый адрес:	Россия, 620003, Екатеринбург, а/я 522
Производитель:	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

www.treaton.ru

БРУТТО КГ

НЕТТО КГ


100% влажность, +50°C, 80% RH, 100% влажность, -50°C, 5°C, 40°C

транспортирование хранение


Гарантийный срок хранения - 6 месяцев




29. Упаковка транспортная и ее маркировка

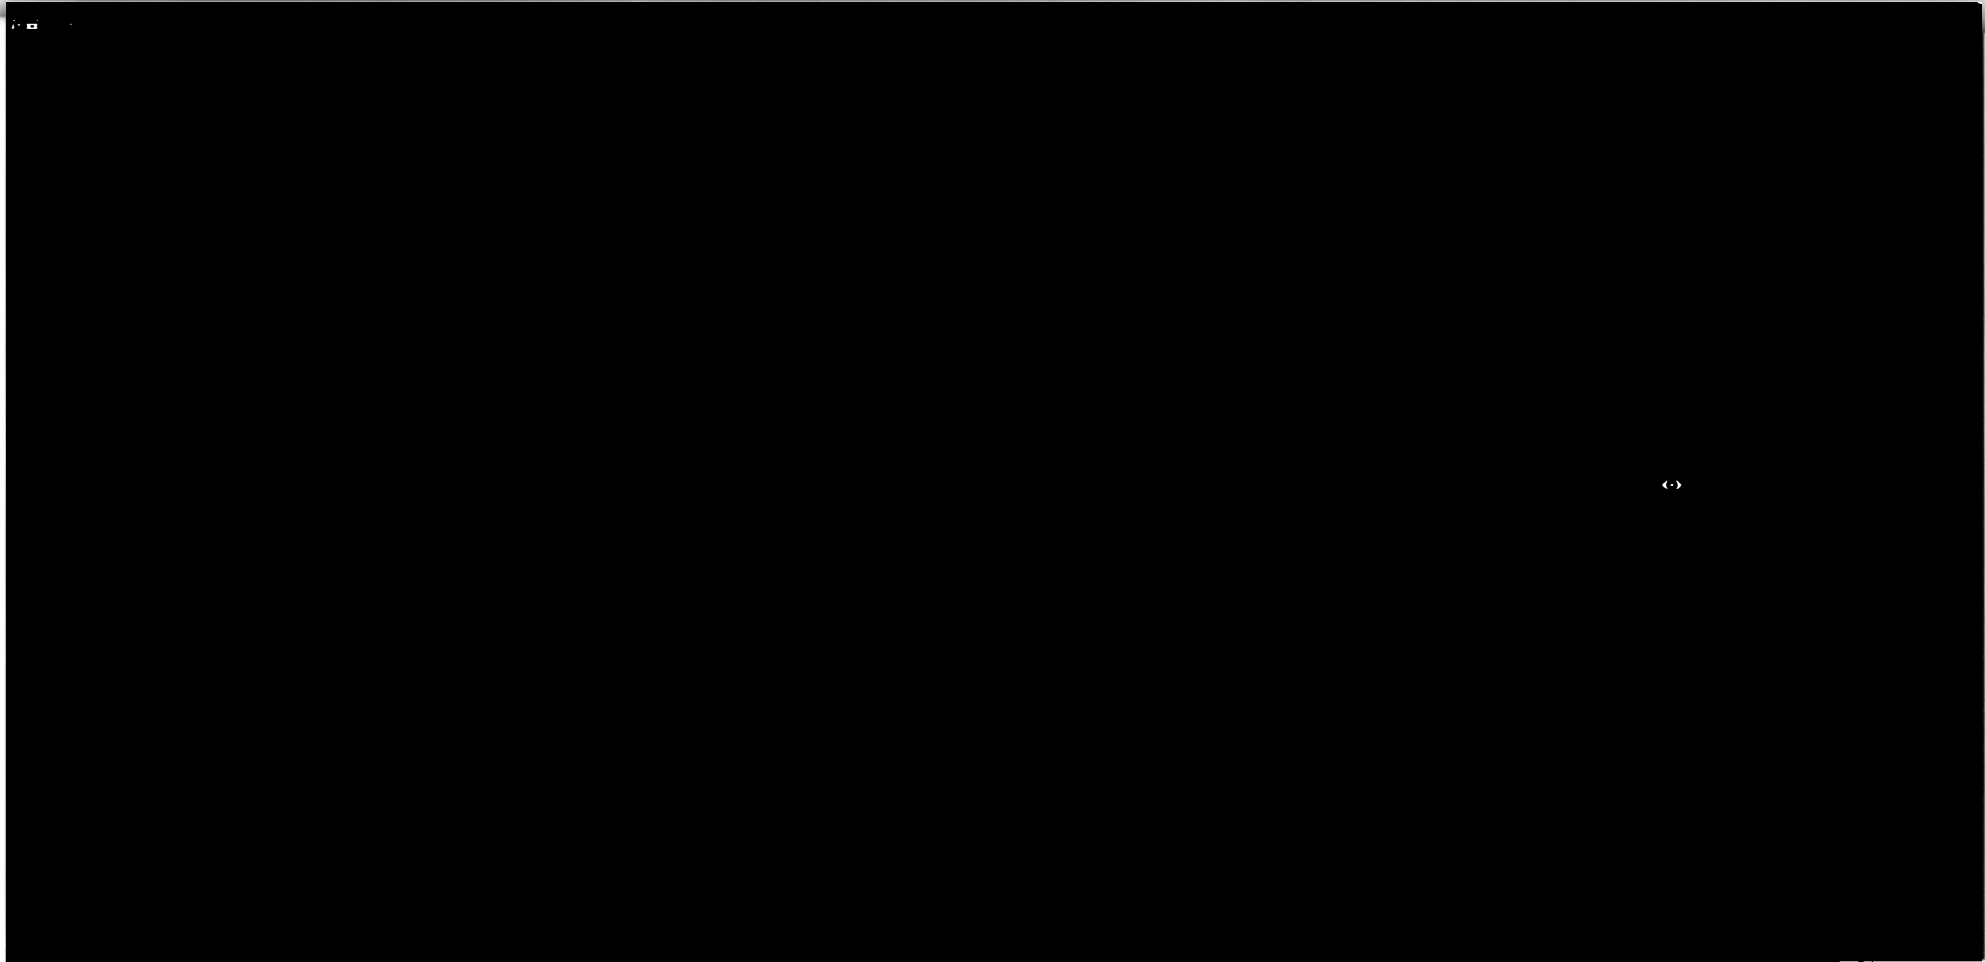

30. Интерфейс станции до 16 пациентов (окно авторизации)

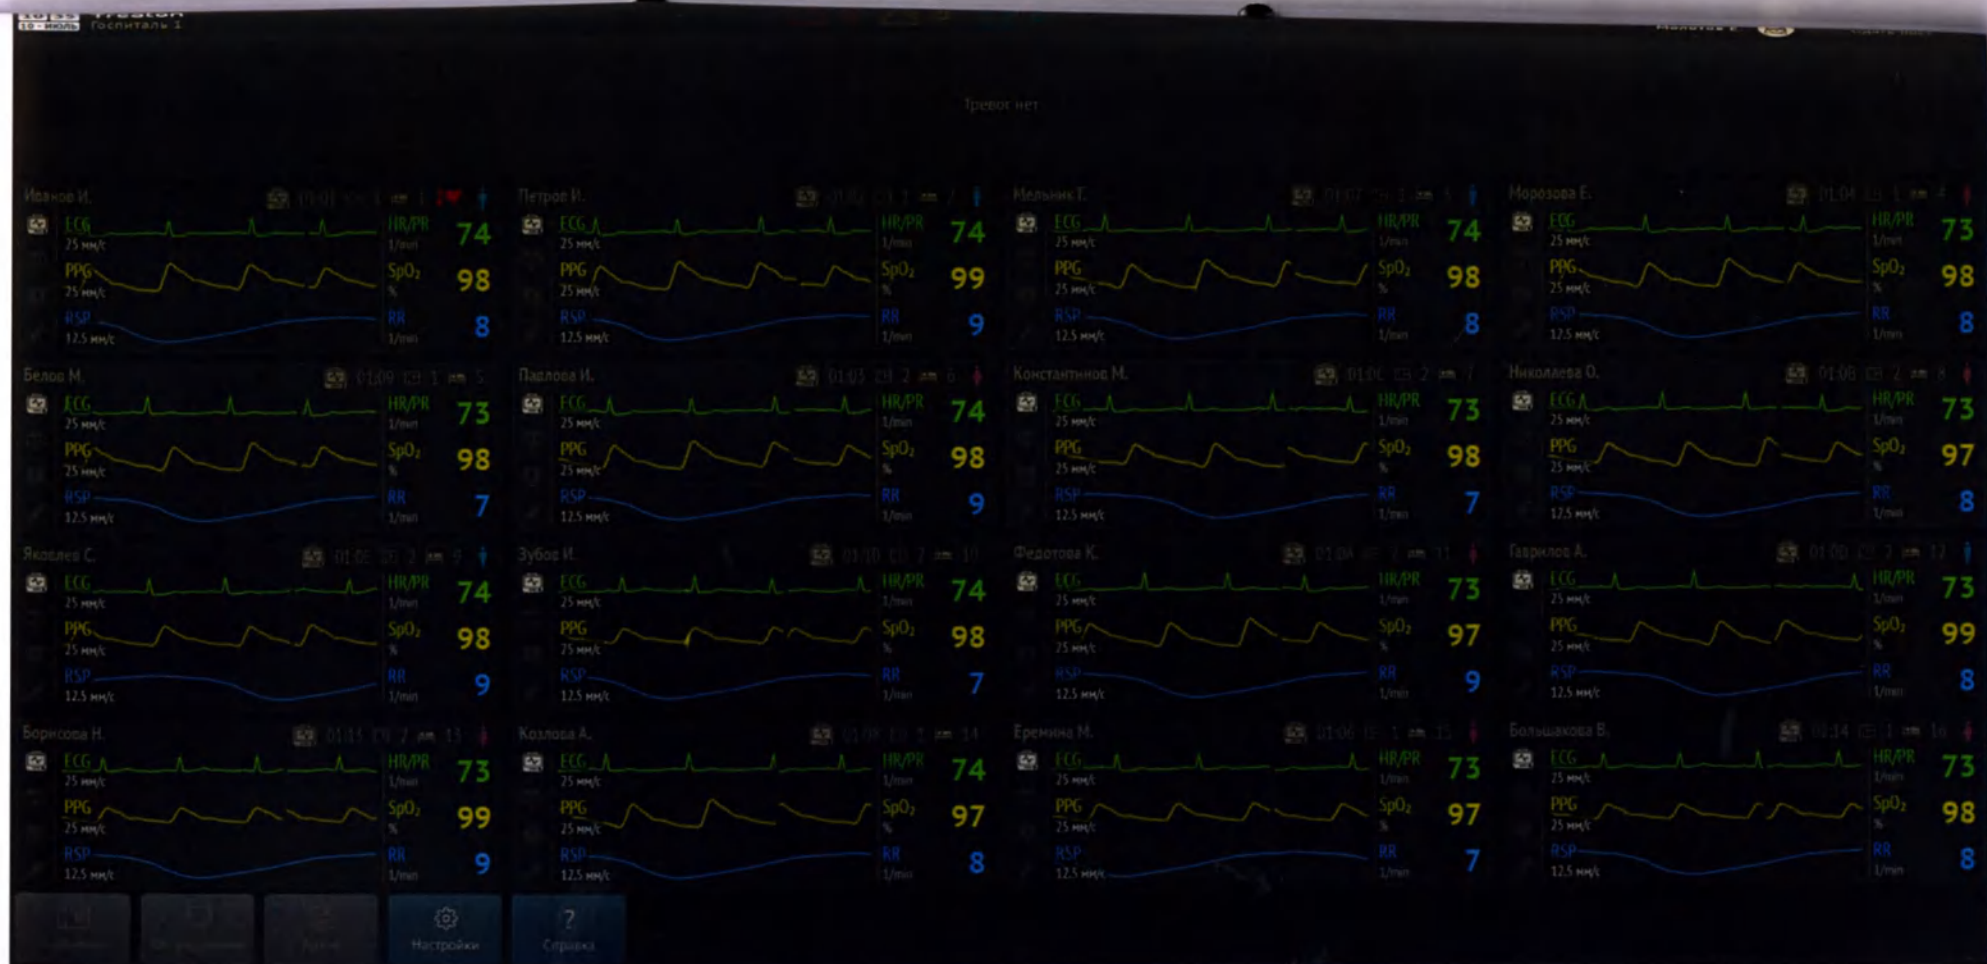


31. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Общий мониторинг»)

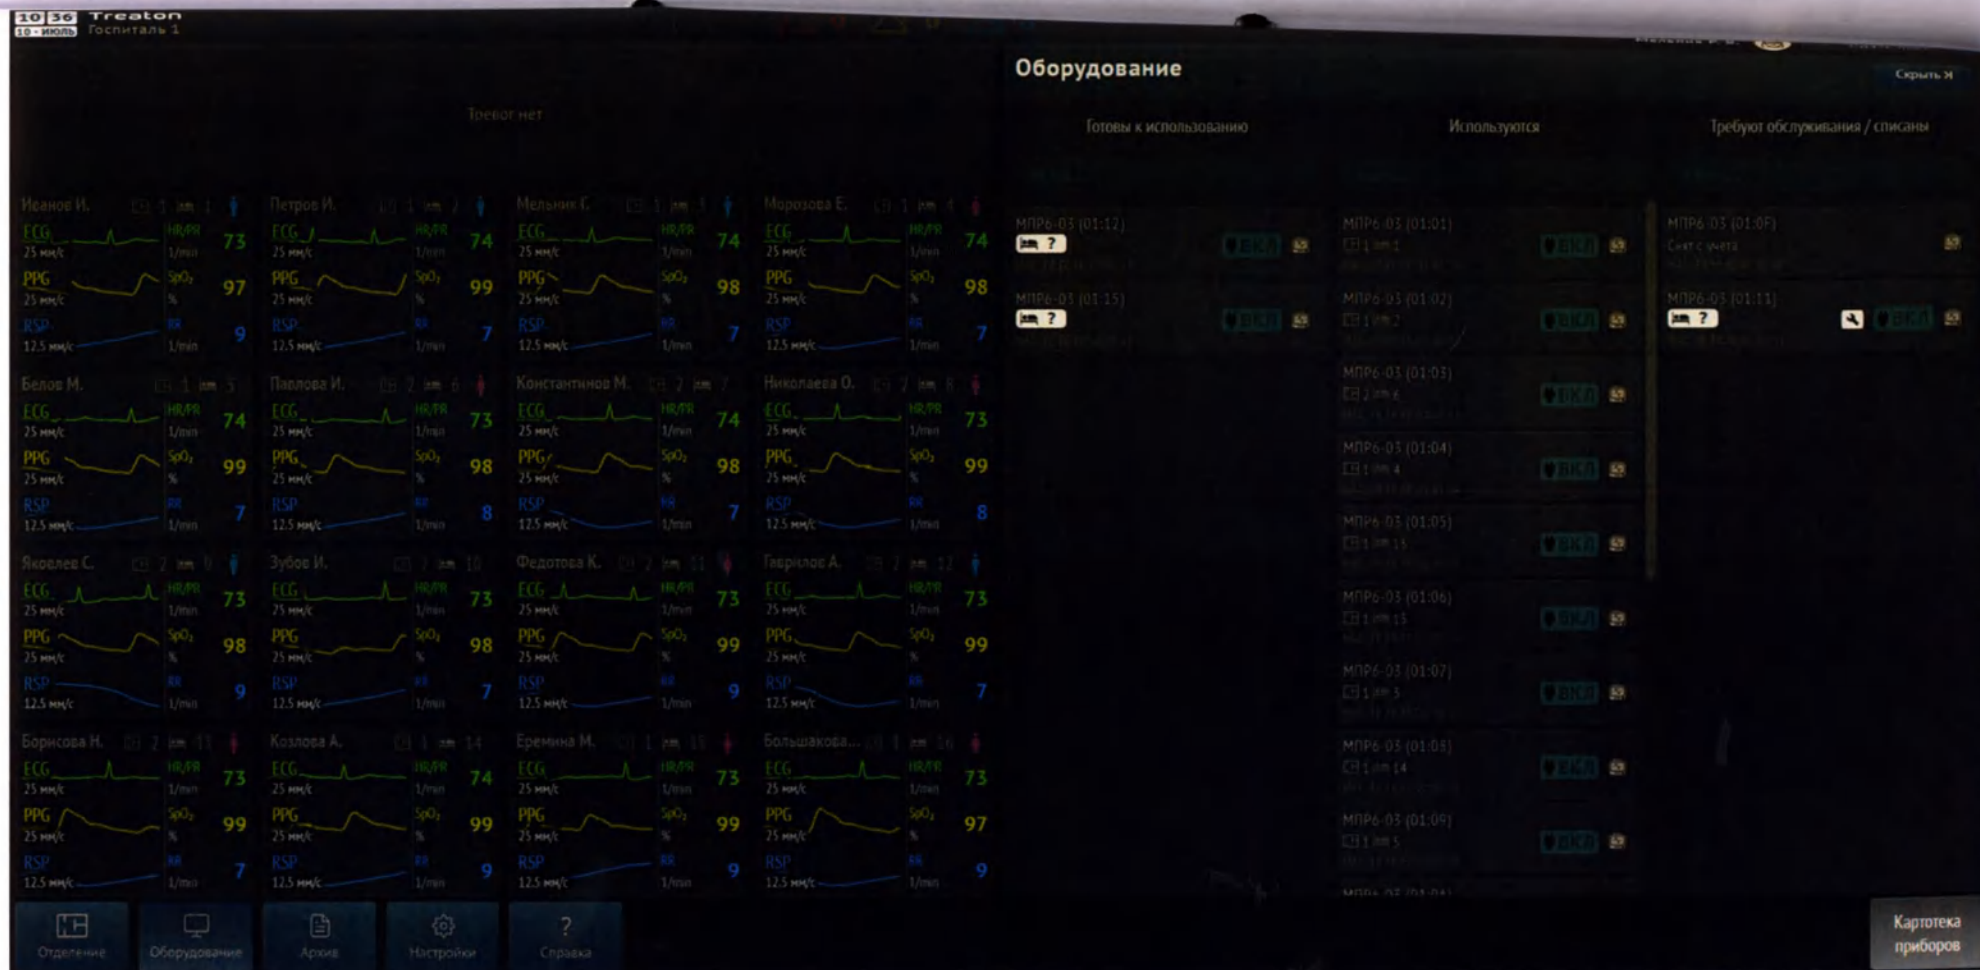


33. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Оборудование»)



34. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Отделение»)

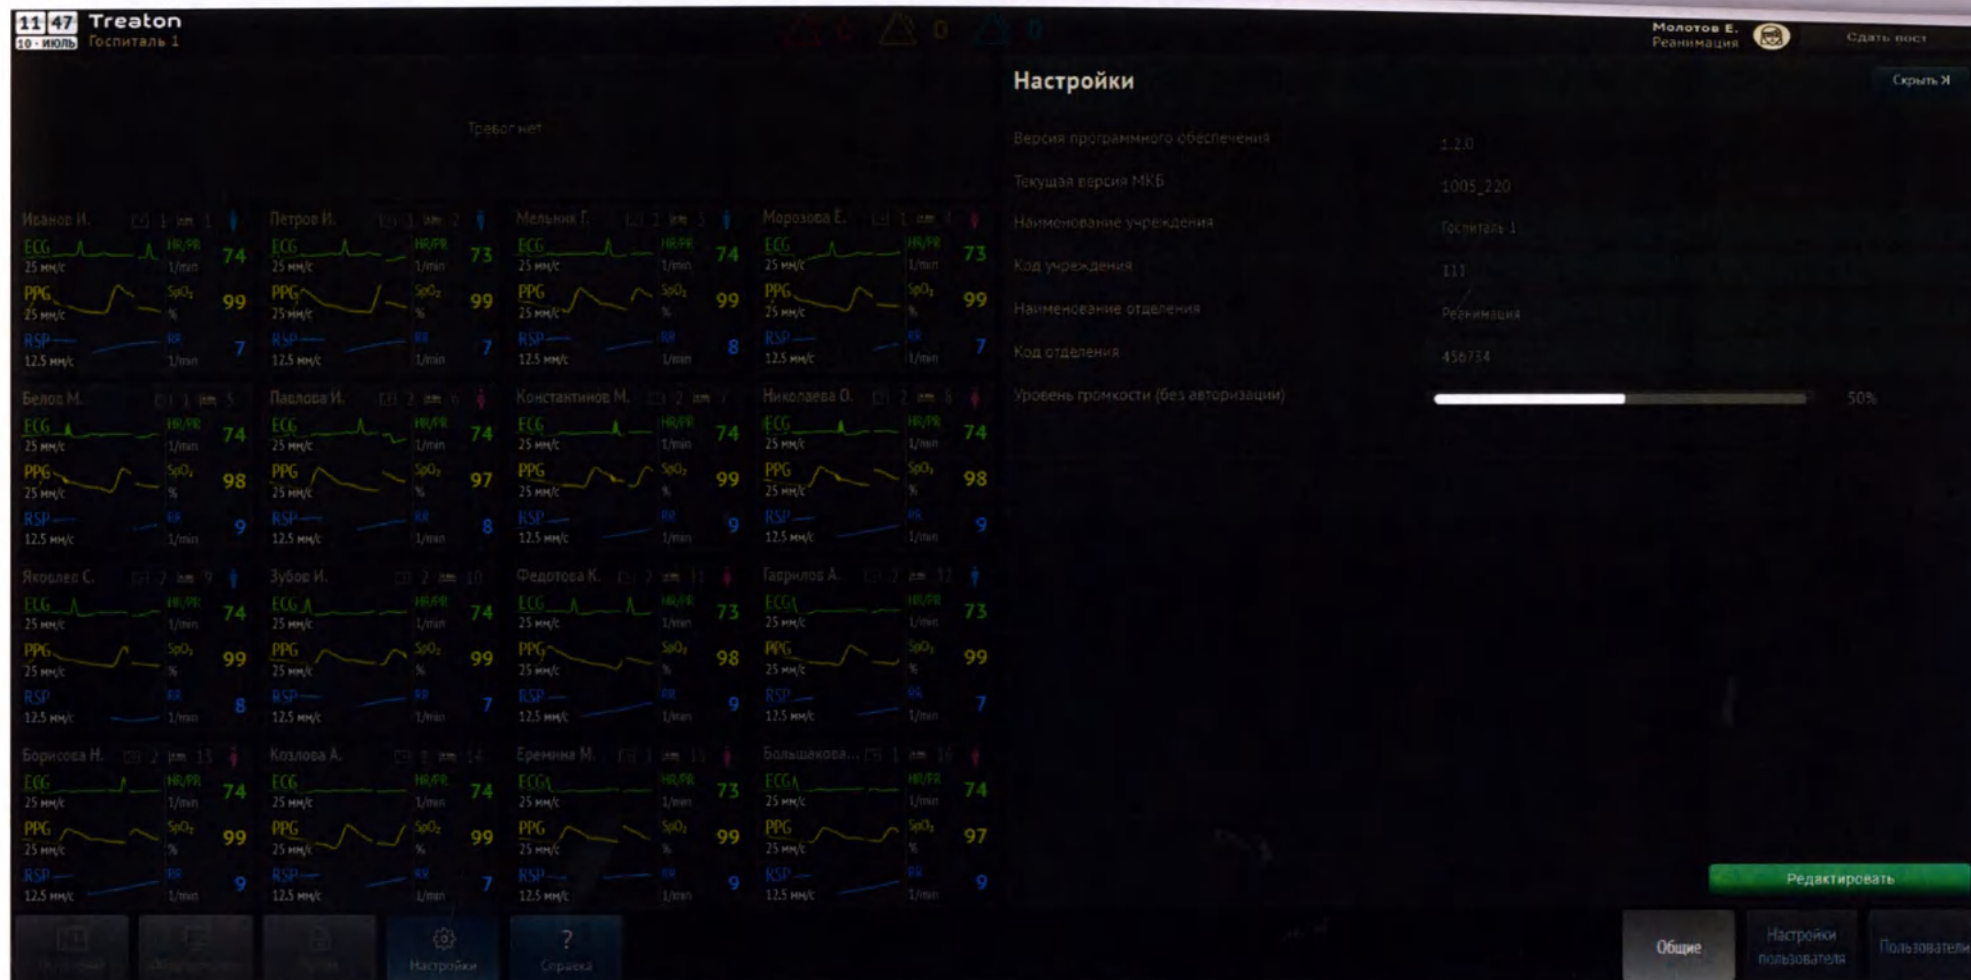


35. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Настройки»)

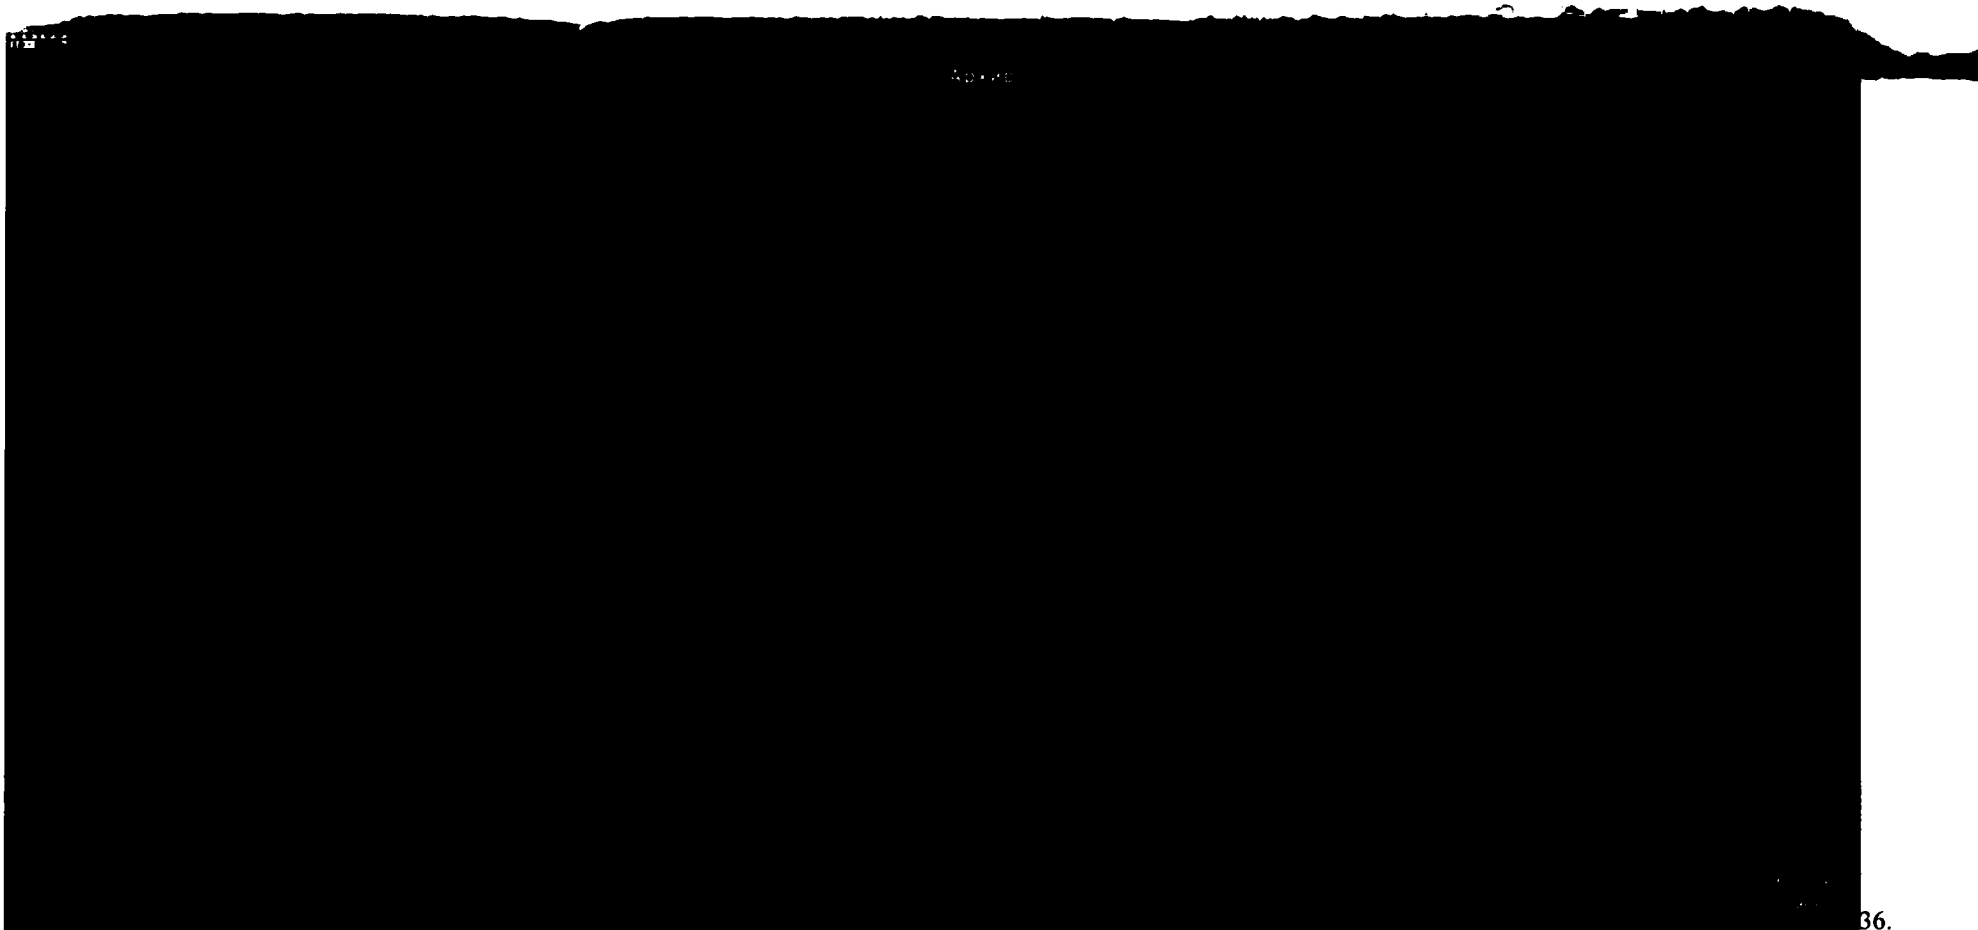

36.

Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Архив»)

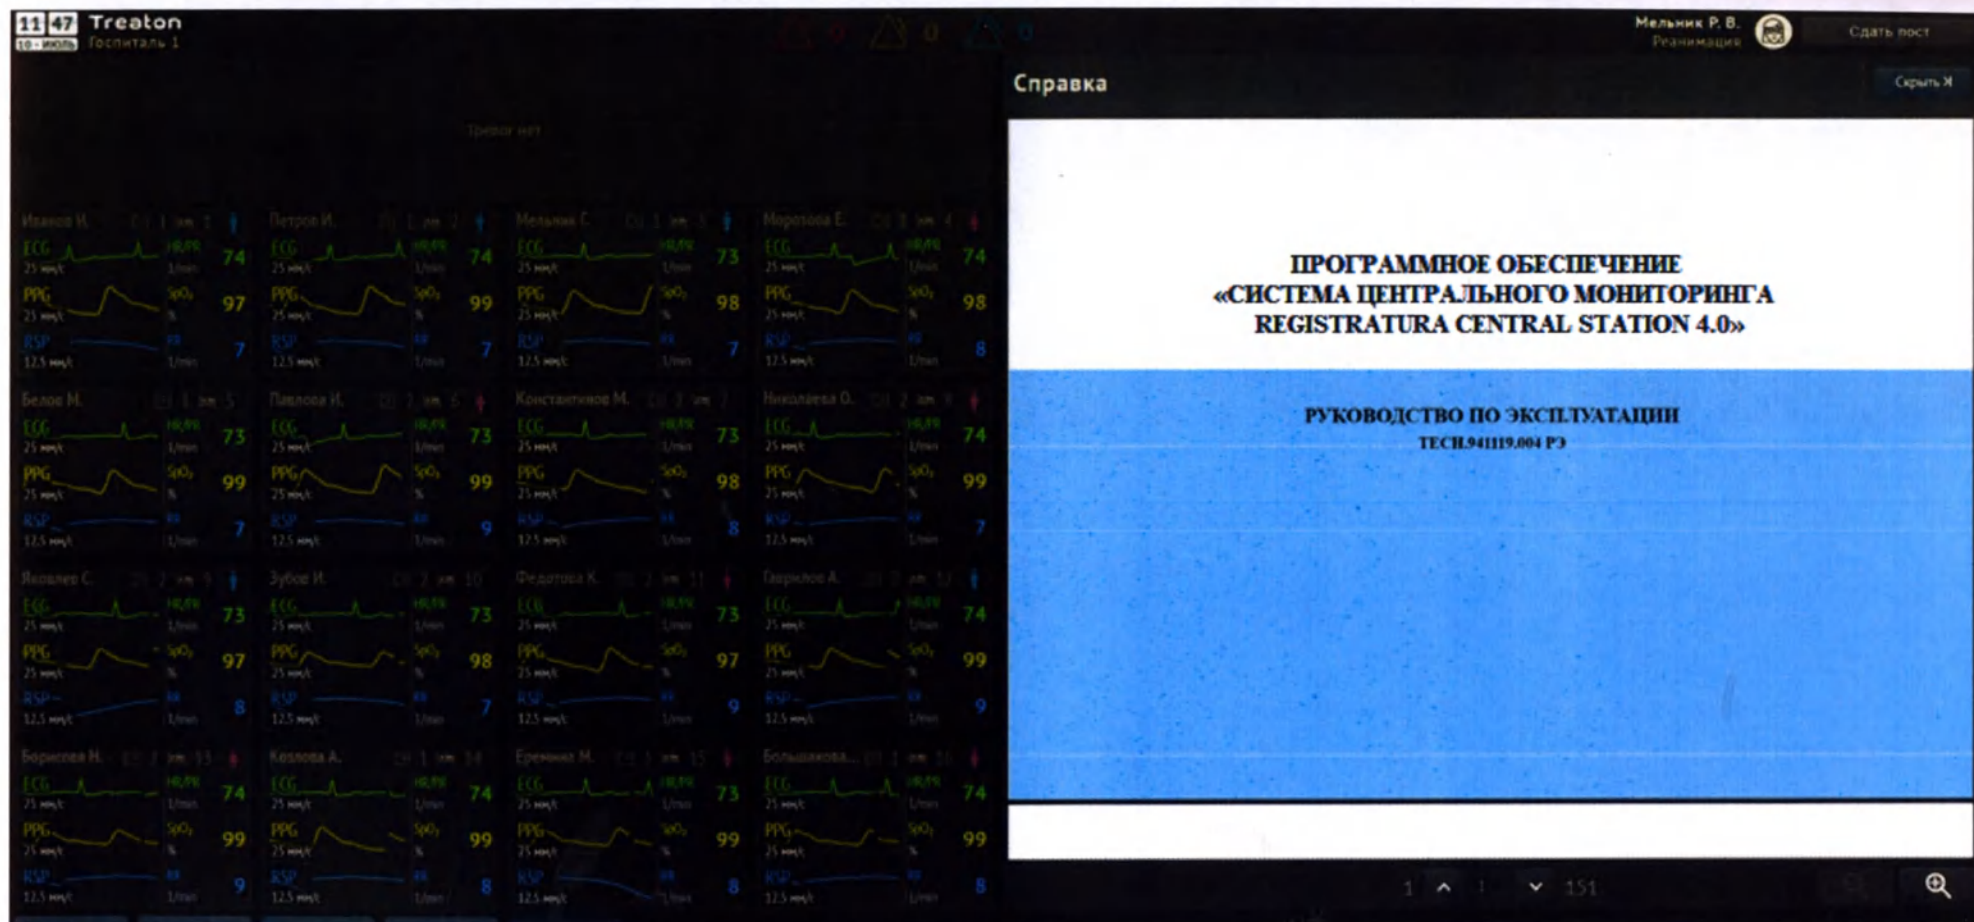

37. Интерфейс станции до 16 пациентов (раздел «Справка»)



38. Интерфейс станции до 32 пациентов (окно авторизации)



39. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Общий мониторинг»)




40. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Индивидуальный мониторинг»)



41. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Оборудование»)




42. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Отделение»)

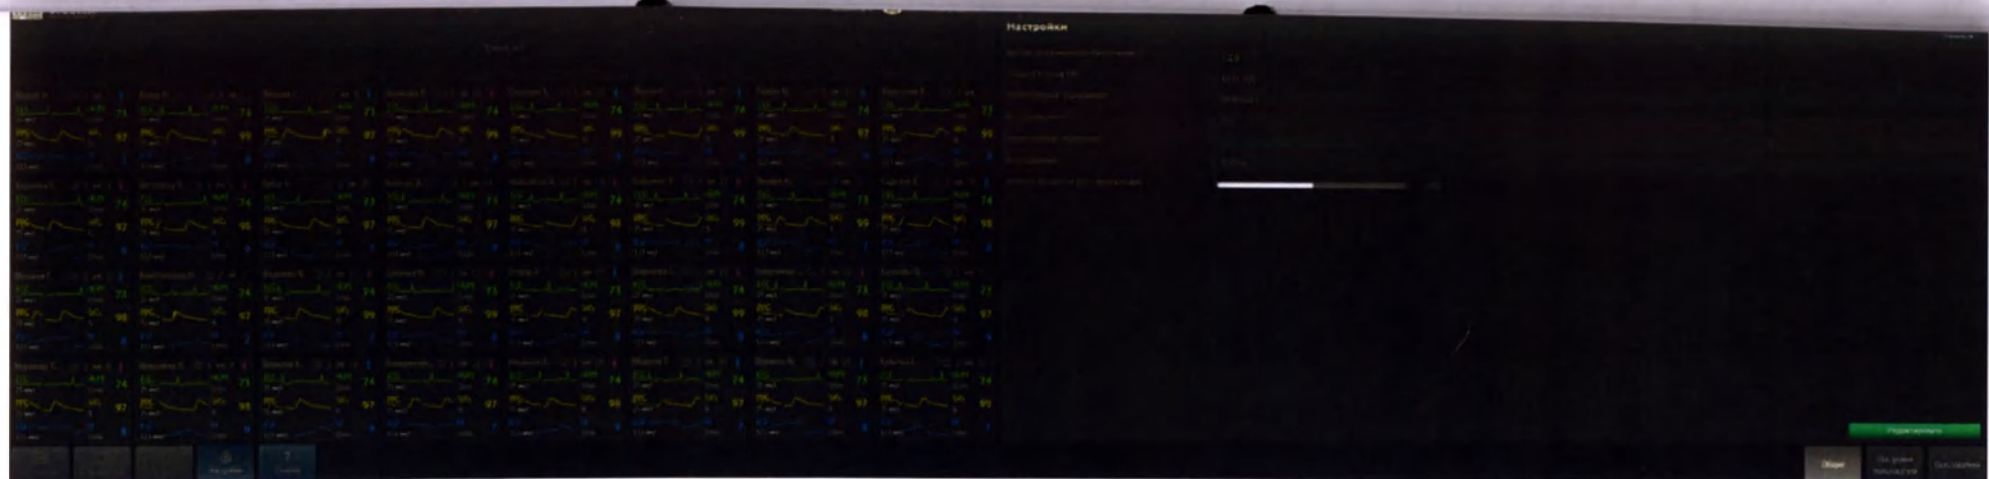

43. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Настройки»)




44. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Архив»)

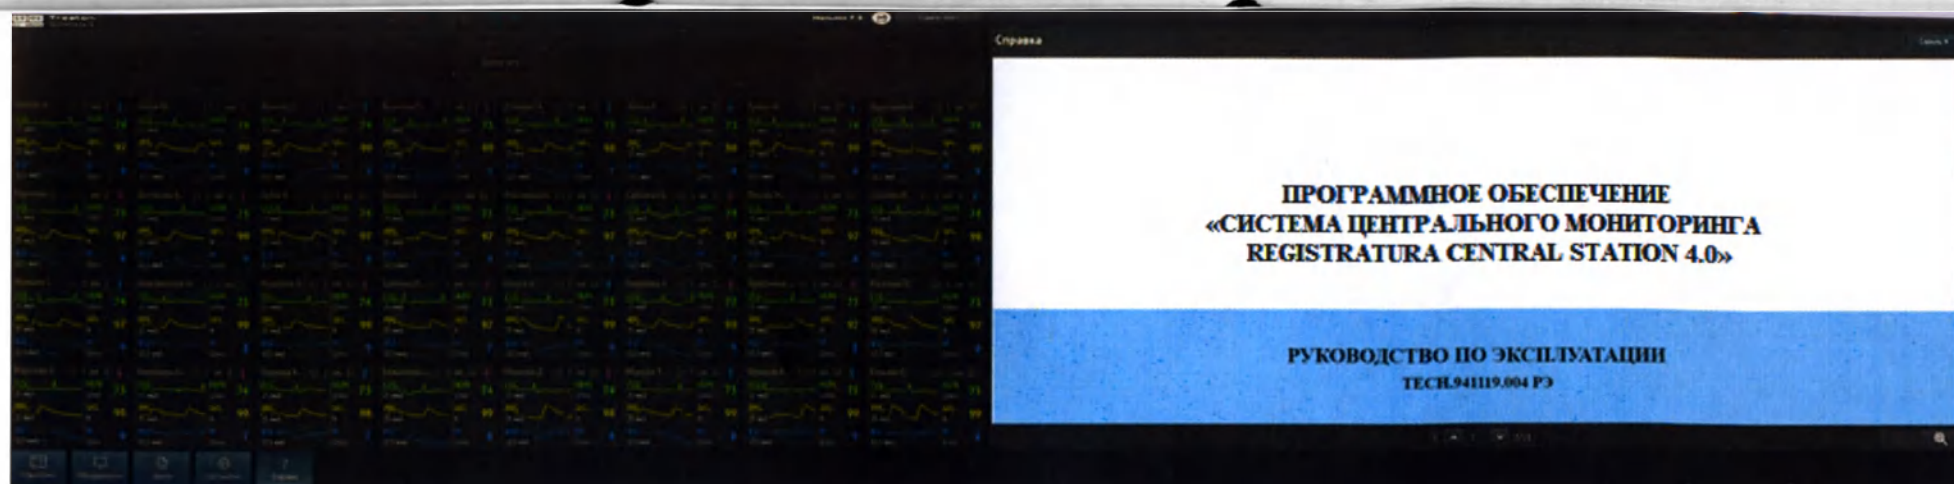

45. Интерфейс станции до 32 пациентов (раздел «Справка»)

прошито, пронумеровано, 47 лист ав
скреплено печать
Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

 Полунин В. М.

«27» 11 2024г.



ТЭСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 1 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------



Булаев В.В.

Данные о маркировке и упаковке.
Программное обеспечение
«Система центрального мониторинга
Registratura Central Station 4.0»

Разработал:


Начальник отдела МИТ
Курганский А.А.

Дата: 12.11.2024

TECH.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 2 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

1 Маркировка накопителя с ПО

TECH.467379.000

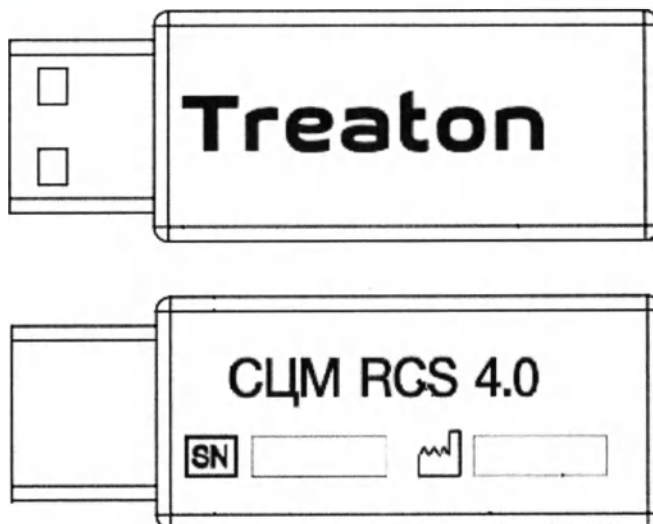


ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 3 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------


2 Транспортная маркировка

№ п/п	Наименование	Обозначение
1	Ящик деревянный	ТЕСН.321231.001
		ТЕСН.321231.001-01
1.1	Наклейка	ТЕСН.754463.002
1.2	Наклейка	ТЕСН.754463.003
1.3	Наклейка	ТЕСН.754463.004
1.4	Наклейка	ТЕСН.539907
1.5	Манипуляционные знаки (на упаковку транспортную по трафарету)	—
2	Коробка	ТЕСН.323229.006
2.1	Наклейка	ТЕСН.754463.001

ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 4 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

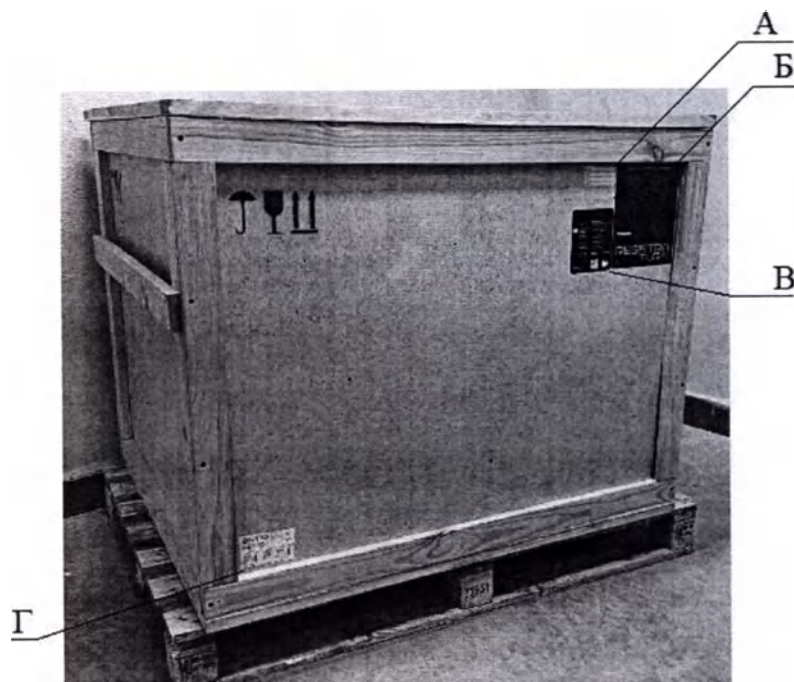TECH.321231.001

TECH.321231.001-01

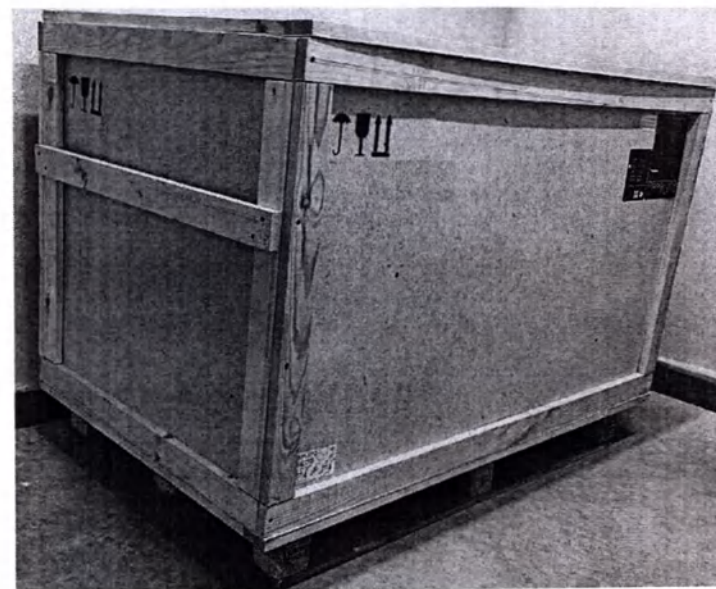


TECH.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 5 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------


А: TECH.754463.002

SN	
	
РУ	
N ₂	

Б: TECH.754463.003

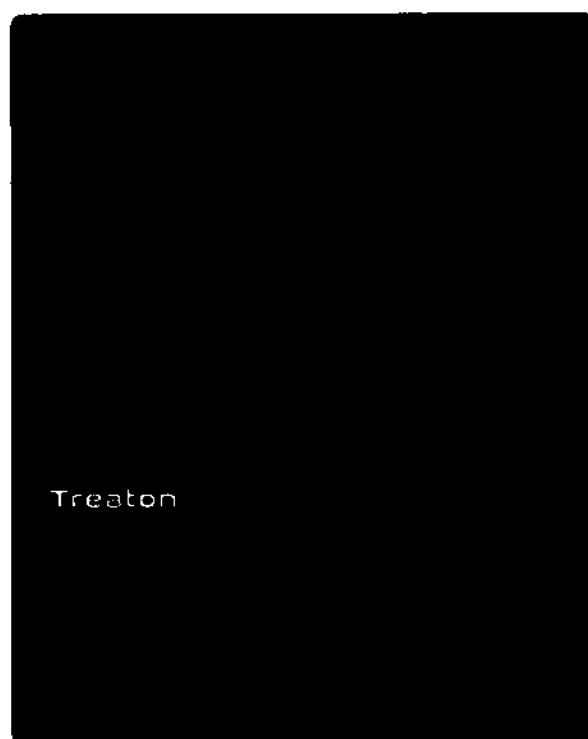

В: TECH.754463.004

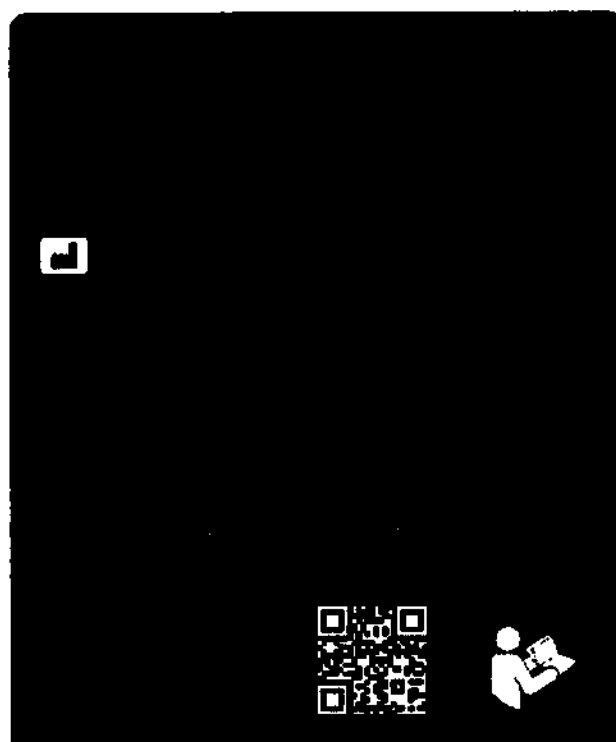

TECH.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 6 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

Г: TECH.539907


Манипуляционные знаки



ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 7 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

ТЕСН.323229.006

Б

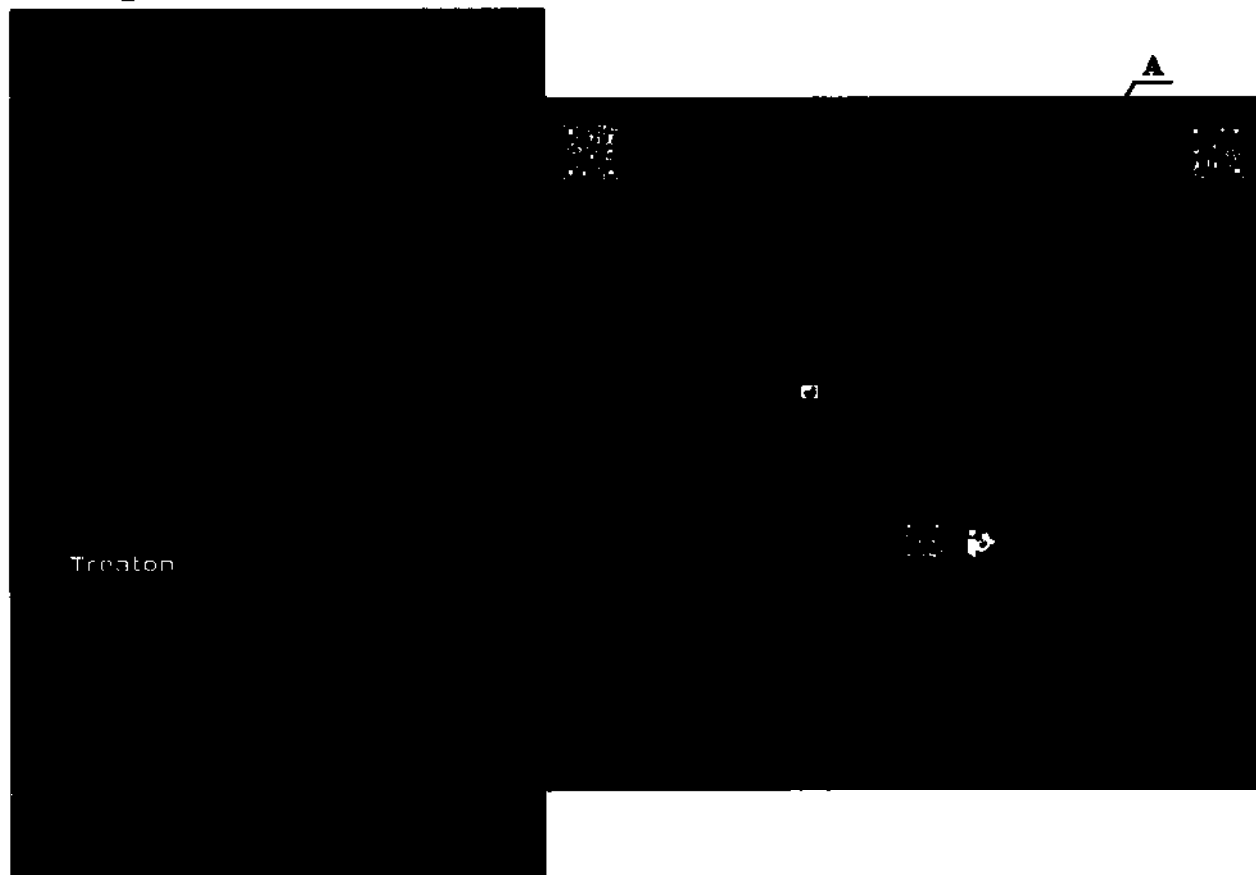

ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 7 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

ТЕСН.323229.006

Б

А



Treaton

TECH.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 8 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

A: TECH.754463.004

TECH.941119.004 IV

Юридический адрес	Россия, 620027, Екатеринбург, Шевченко, 9–217
 Адрес места производства	Россия, 620133, Екатеринбург, Бажова, 33
Сервисная служба	+7 (343) 304-60-52, +7 (800) 500-80-53
Служба качества	+7 (343) 304-60-50
Почтовый адрес	Россия, 6200063, Екатеринбург, а/я 522
Производитель	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»

mail@treaton.ru
www.treaton.ru




Б: TECH.754463.001

SN	
	
РУ	

ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 9 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	---------------------------------

3 Упаковка

Накопитель с программным обеспечением, электронный ключ защиты, паспорт и руководство по эксплуатации упаковывают в коробку ТЕСН.323229.006 согласно ТЕСН.941119.004 УЧ (Приложение А).

Покупные изделия в упаковке производителя покупных изделий упаковывают согласно ТЕСН.941119.004 УЧ (Приложение А).

ТЕСН.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 10 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	----------------------------------

Приложение А

Перечень ссылочной конструкторской документации на упаковку изделия

Программное обеспечение «Система центрального мониторинга

Registratura Central Station 4.0, ТЕСН.941119.004 ТУ»

Наименование упаковки	Обозначение	Производитель	Обозначение и тип конструкторского документа
Упаковка транспортная в составе:	ТЕСН.323229.004	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЕСН.941119.004 Упаковка транспортная. Спецификация ТЕСН.941119.004 Упаковочный чертеж
Коробка	ТЕСН.323229.006	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЕСН.323229.006 Коробка. Спецификация ТЕСН.323229.006 Коробка
Ящик деревянный	ТЕСН.321231.001	ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС», Россия	ТЕСН.321231.001 Ящик деревянный. Спецификация ТЕСН.321231.001 СБ Ящик деревянный. Сборочный чертеж
	ТЕСН.321231.001-01		ТЕСН.321231.001-01 Ящик деревянный. Спецификация ТЕСН.321231.001-01 СБ Ящик деревянный. Сборочный чертеж

TECH.941119.004 ДМУ	Данные о маркировке и упаковке Программное обеспечение «Система центрального мониторинга Registratura Central Station 4.0»	Страница: 11 из 11 Ревизия: 2
---------------------	---	----------------------------------

Лист учета изменений

№ ревизии	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений
1	30.07.2024	Добавление новых наклеек. Внесение правок в изображения
2	24.10.2024	Актуализировано наименование изделия и изображения наклеек

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 11 лист 26

Директор по качеству
ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС»



В.М. Полунин
«24» 11 2024г.