

Фотографические изображения медицинского изделия
Система автоматизированная микробиологическая масс-спектрометрического анализа MALDI-TOF Autof ms1000 для in vitro диагностики


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации

ООО «ИЛС»




Стариковская И.А.

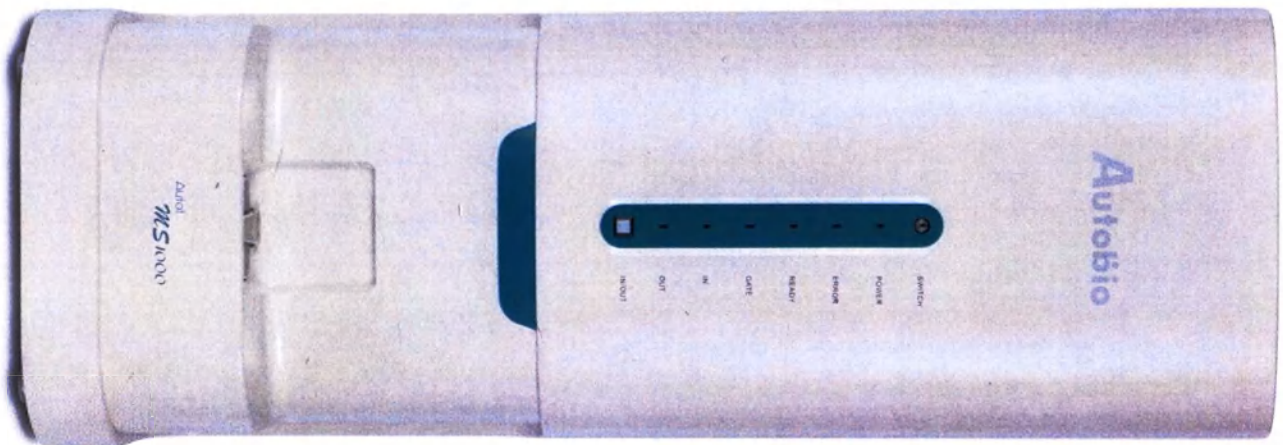







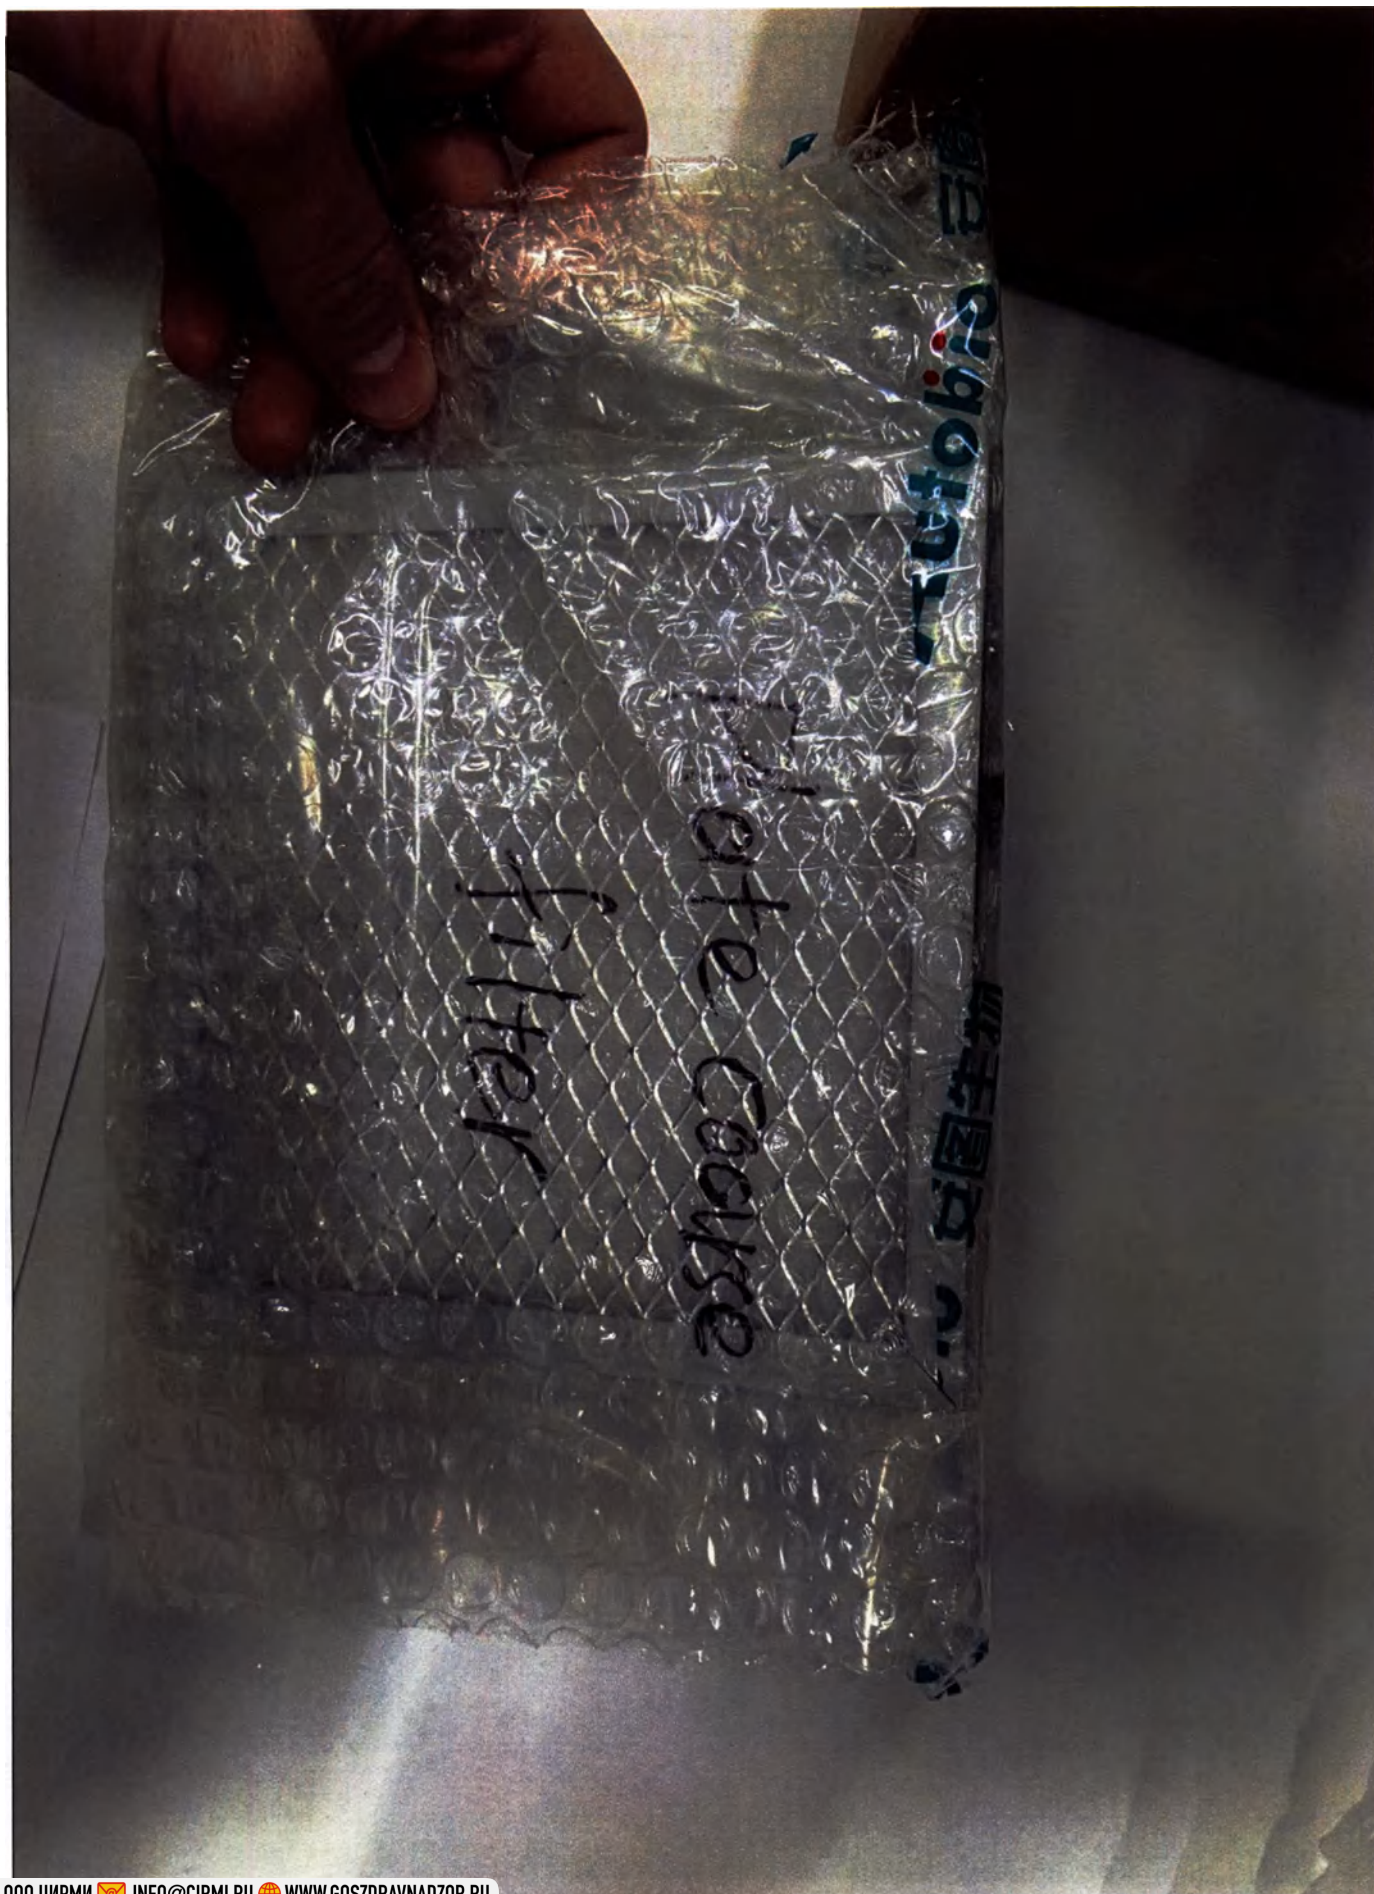

2. Механический насос – 1 шт., в составе: - сиффон, 200 см

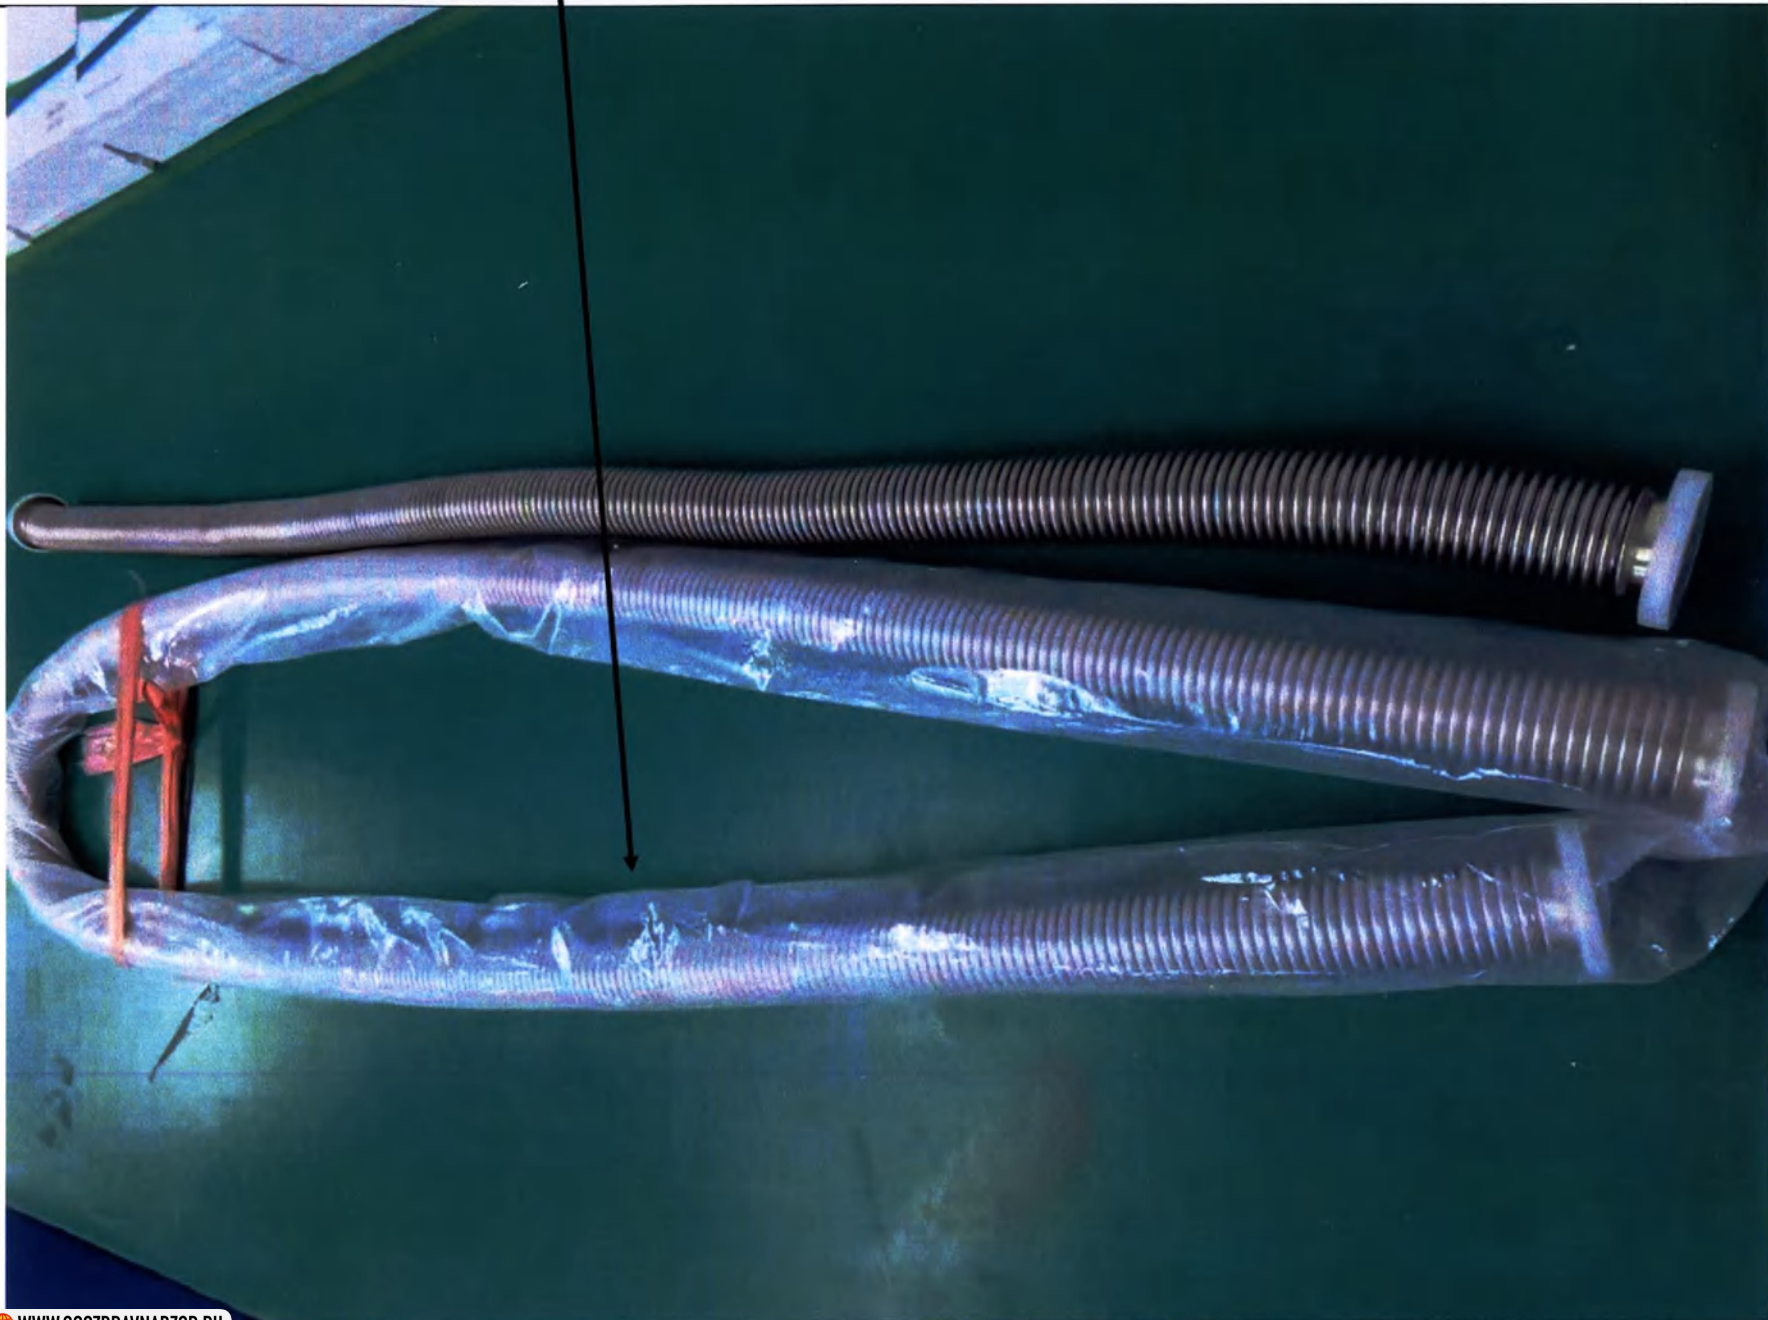


2. Механический насос – 1 шт., в составе: - сиффон, 100 см

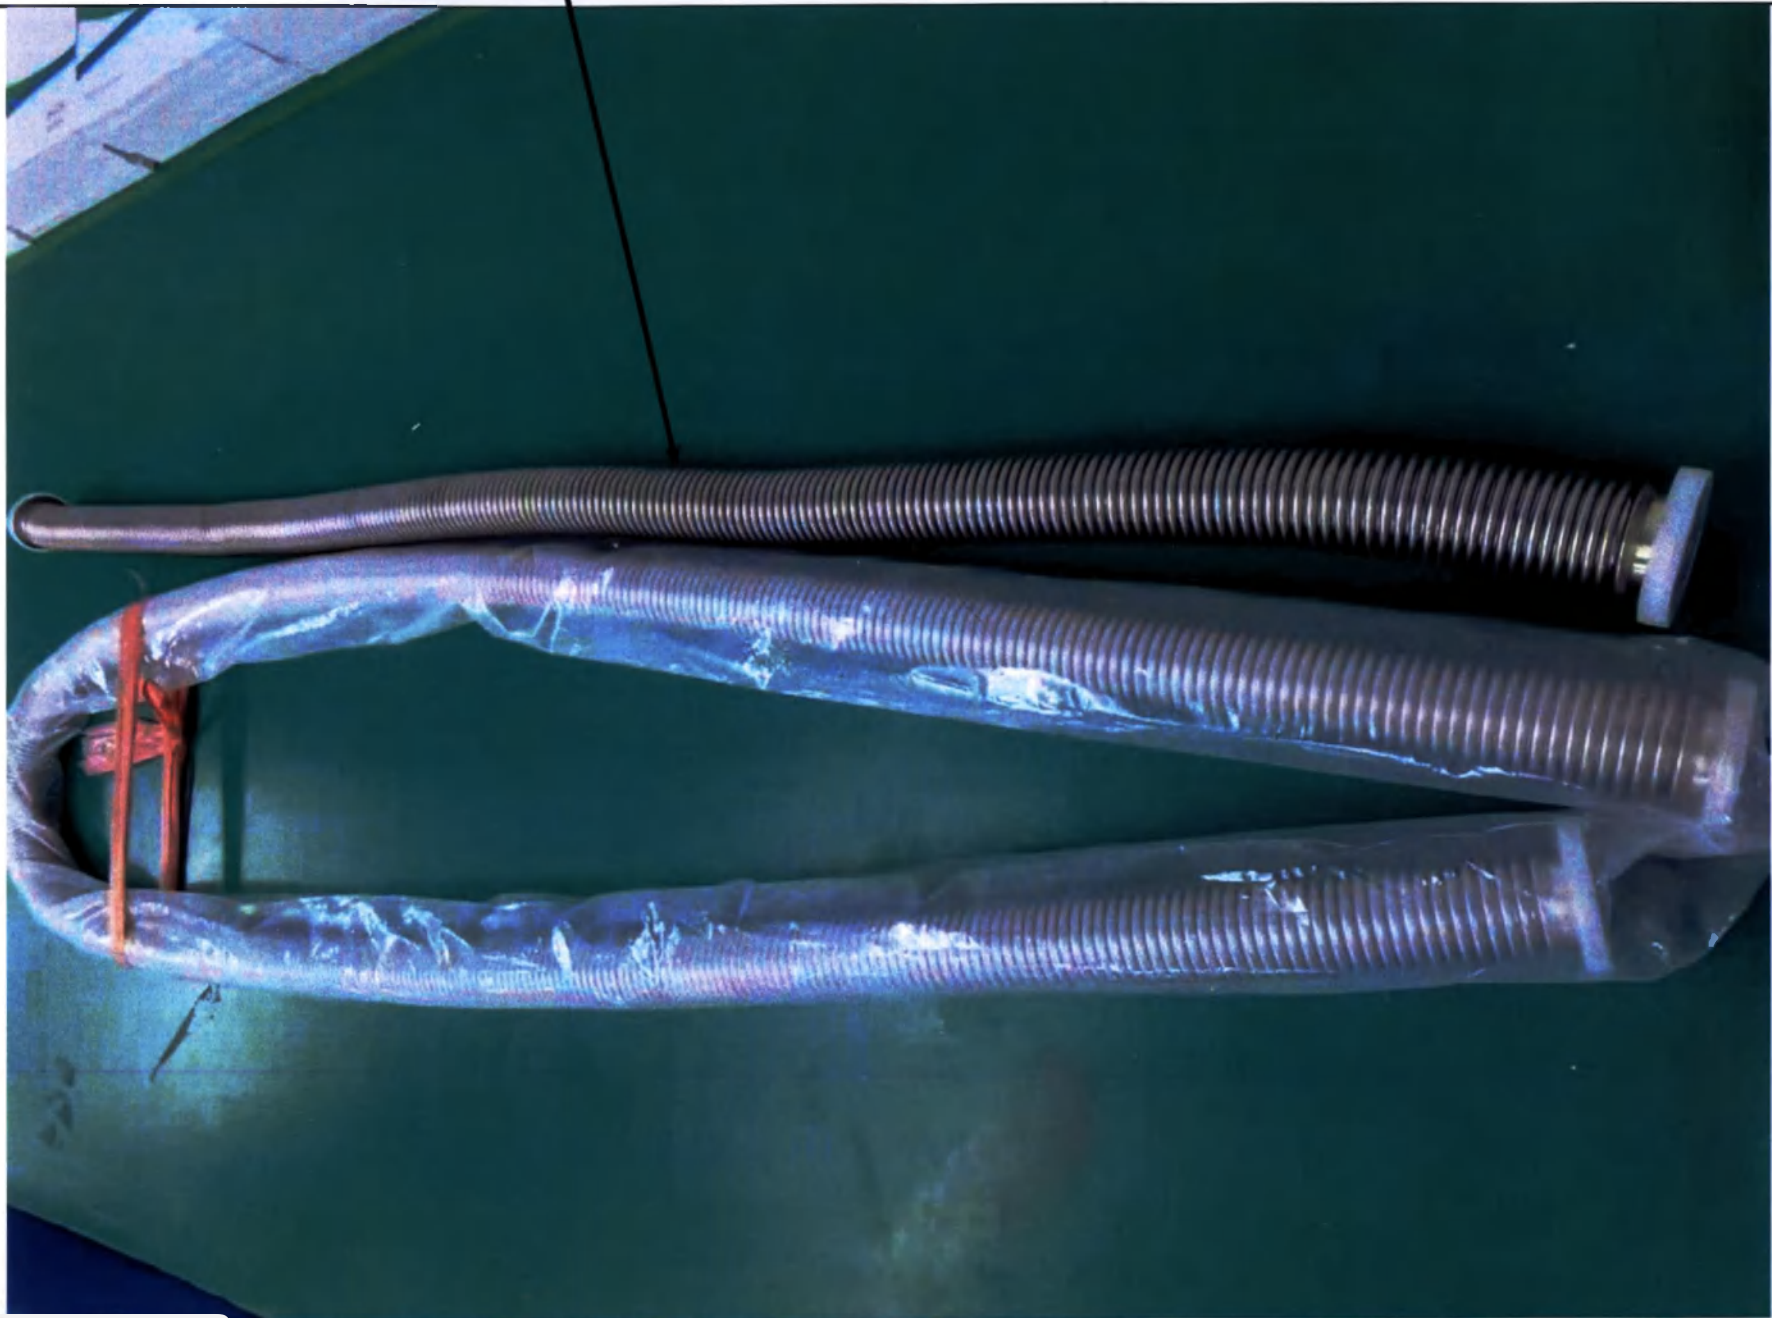





2. Механический насос – 1 шт., в составе: - вакуумное масло DS19



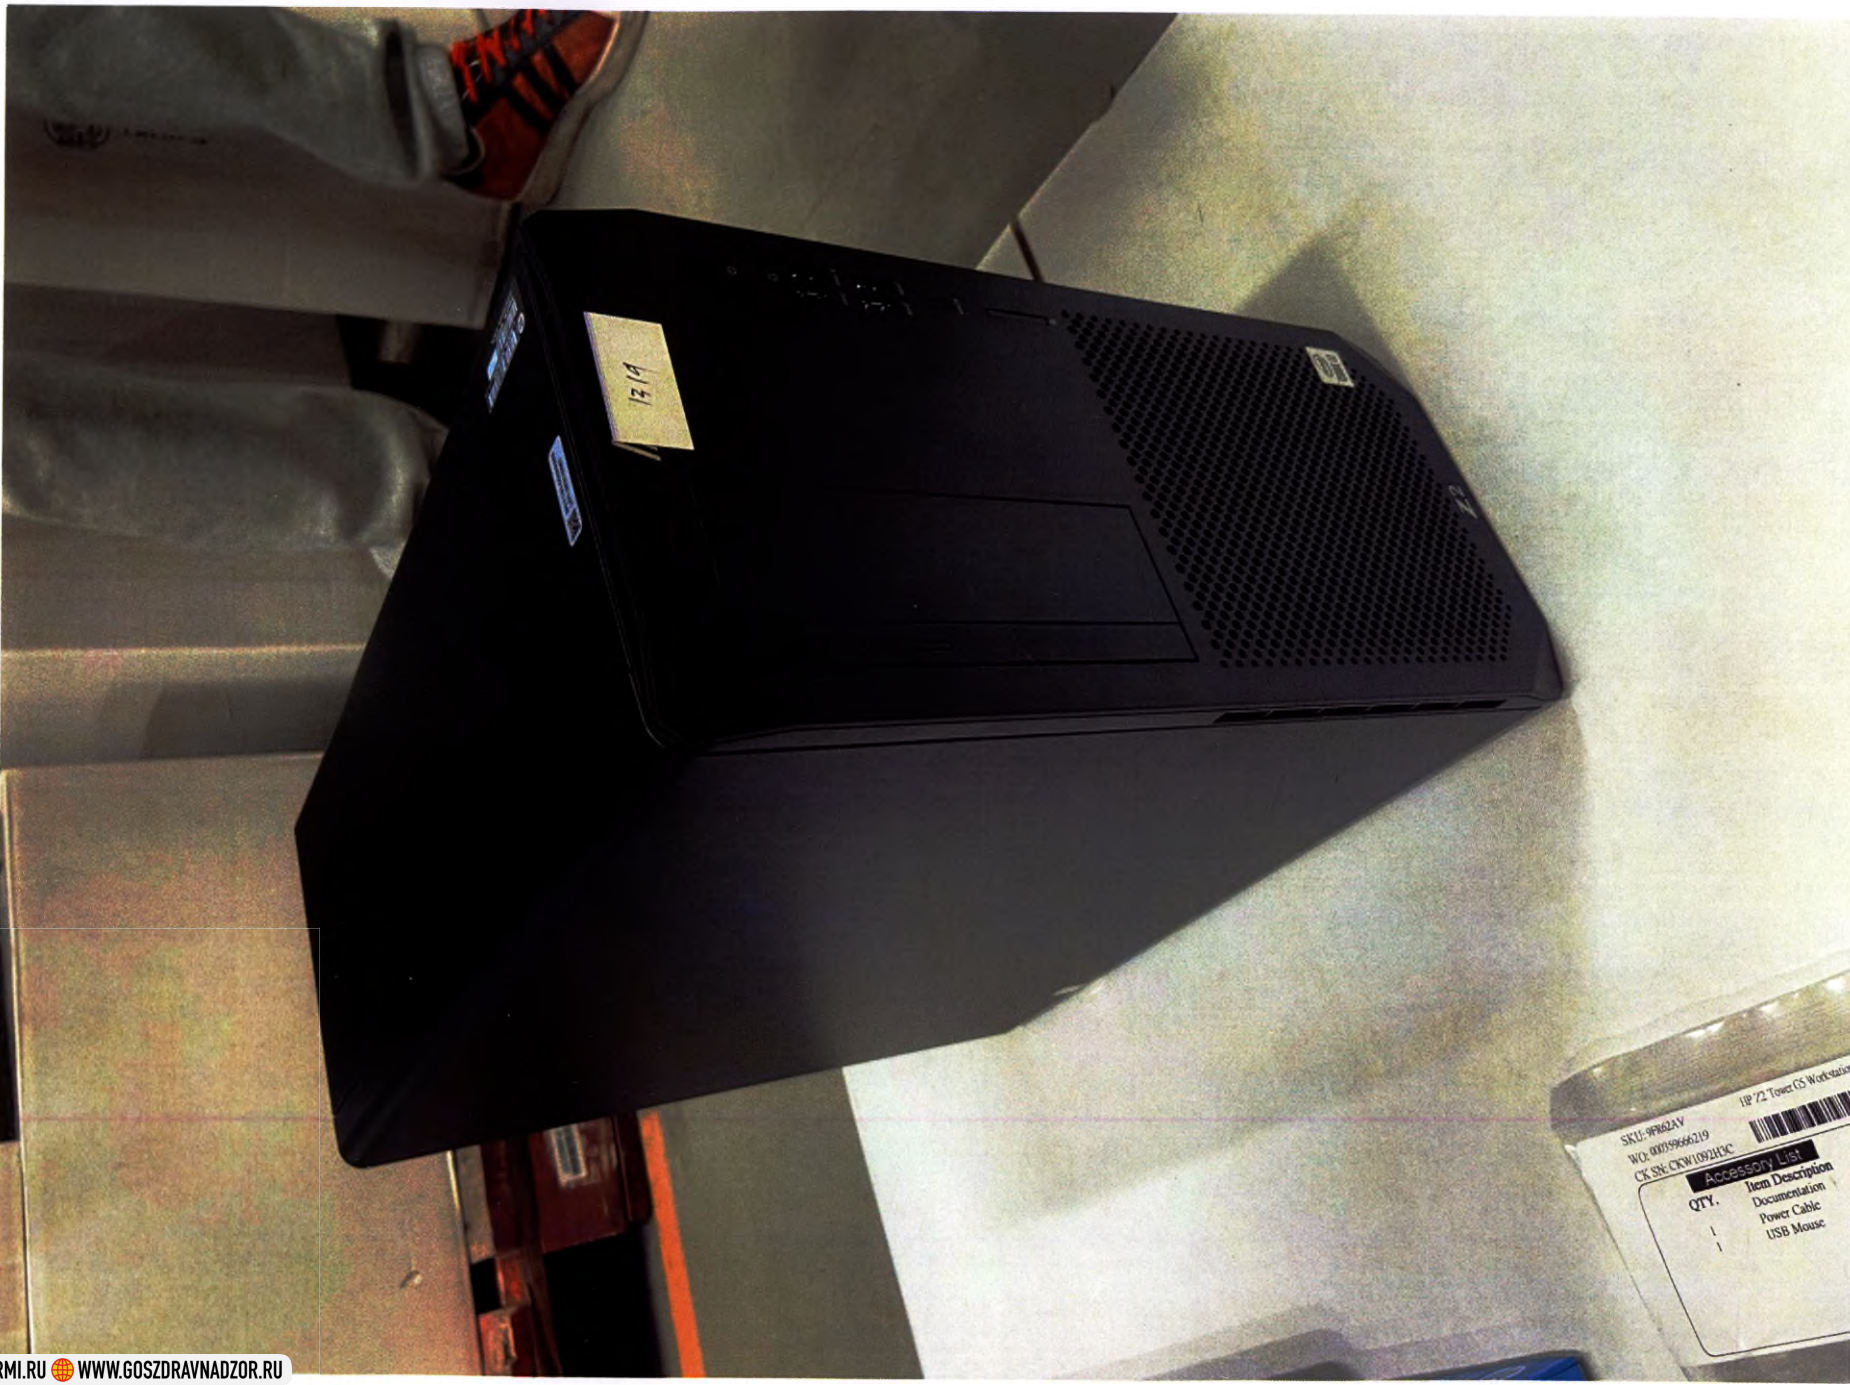



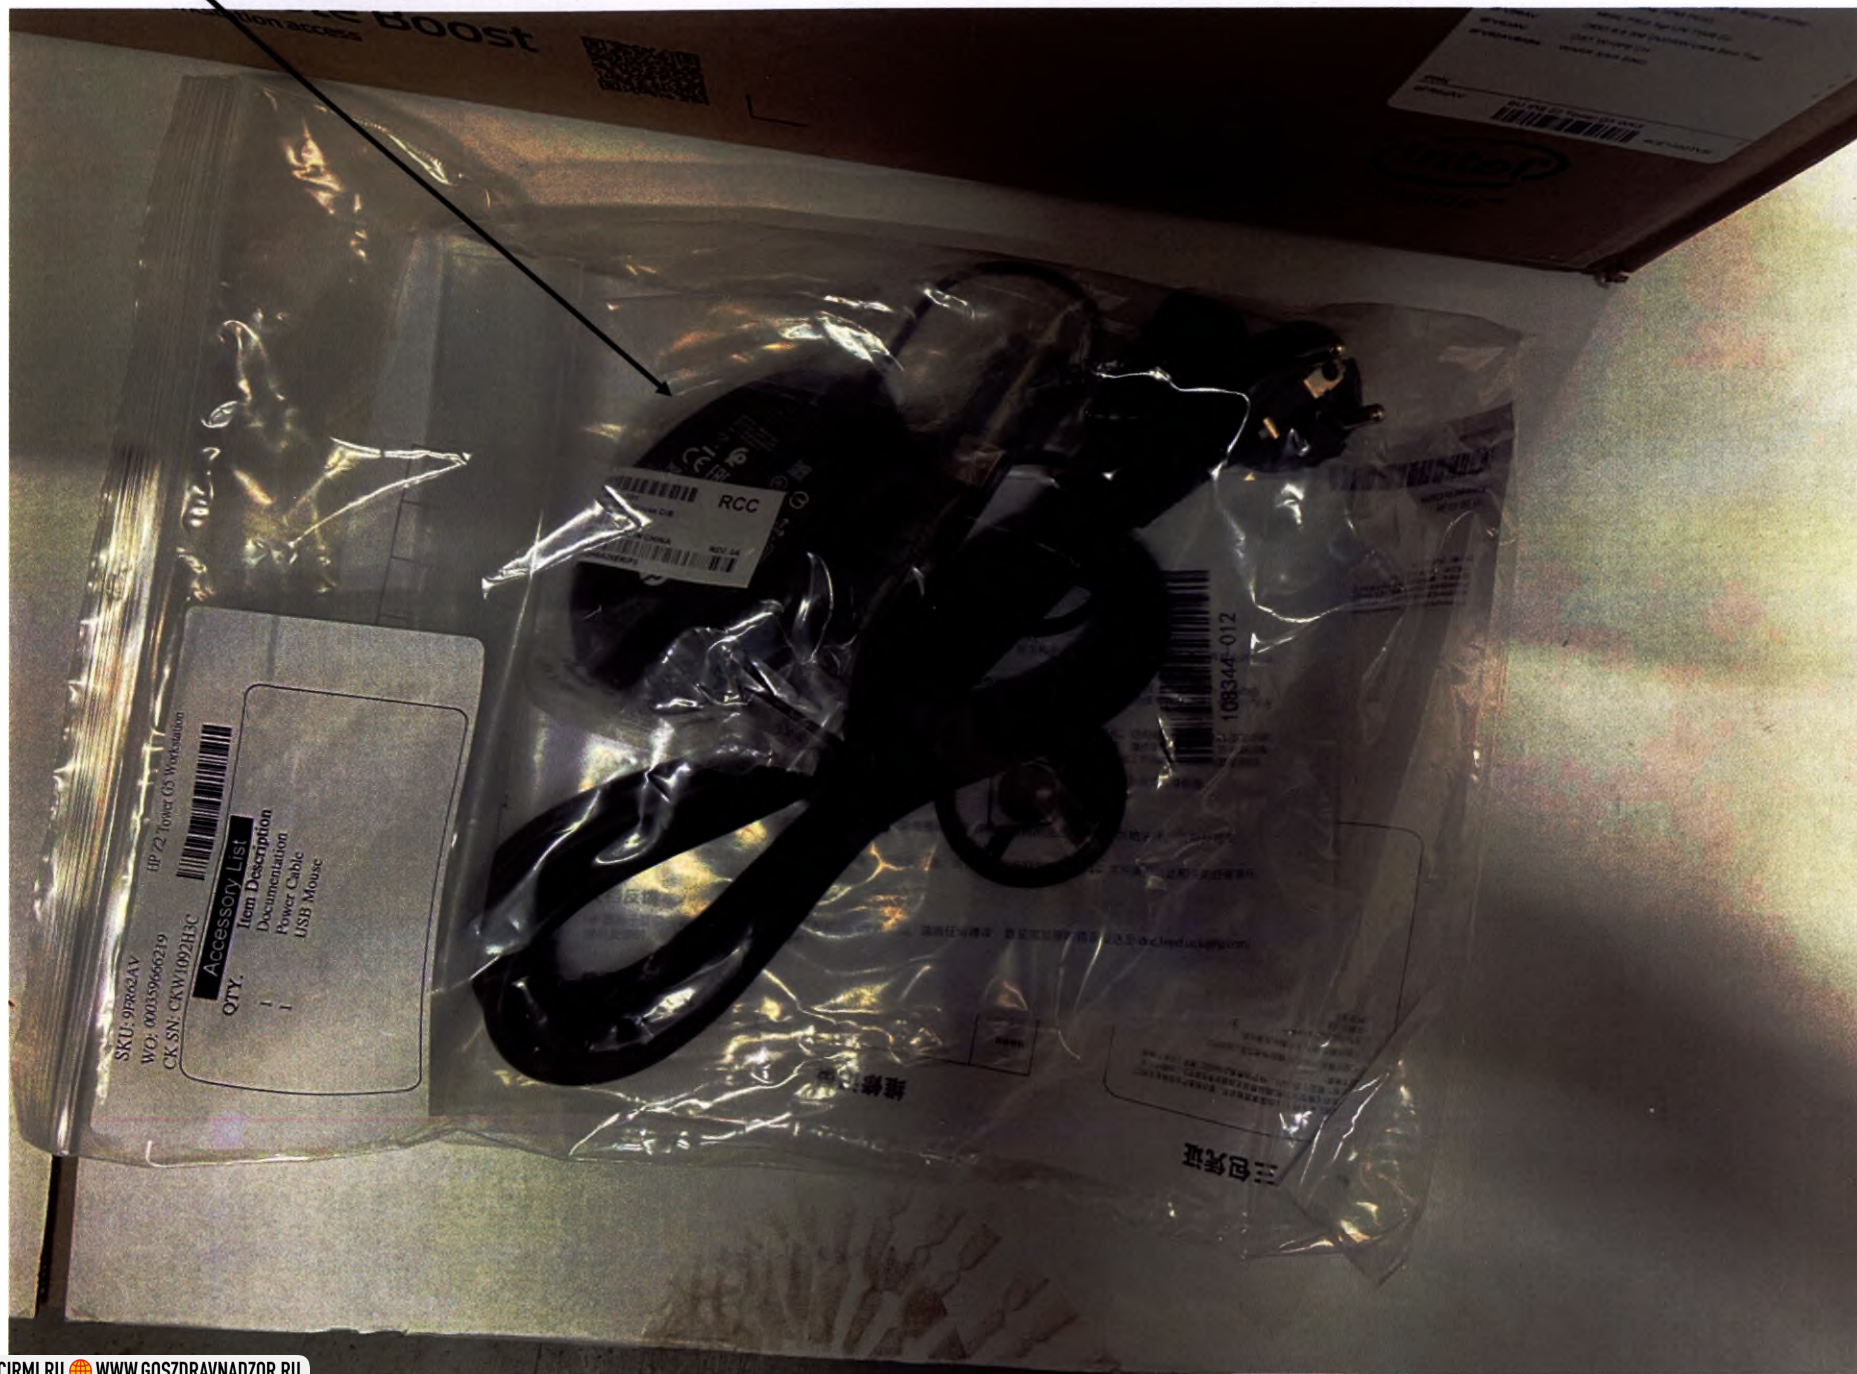

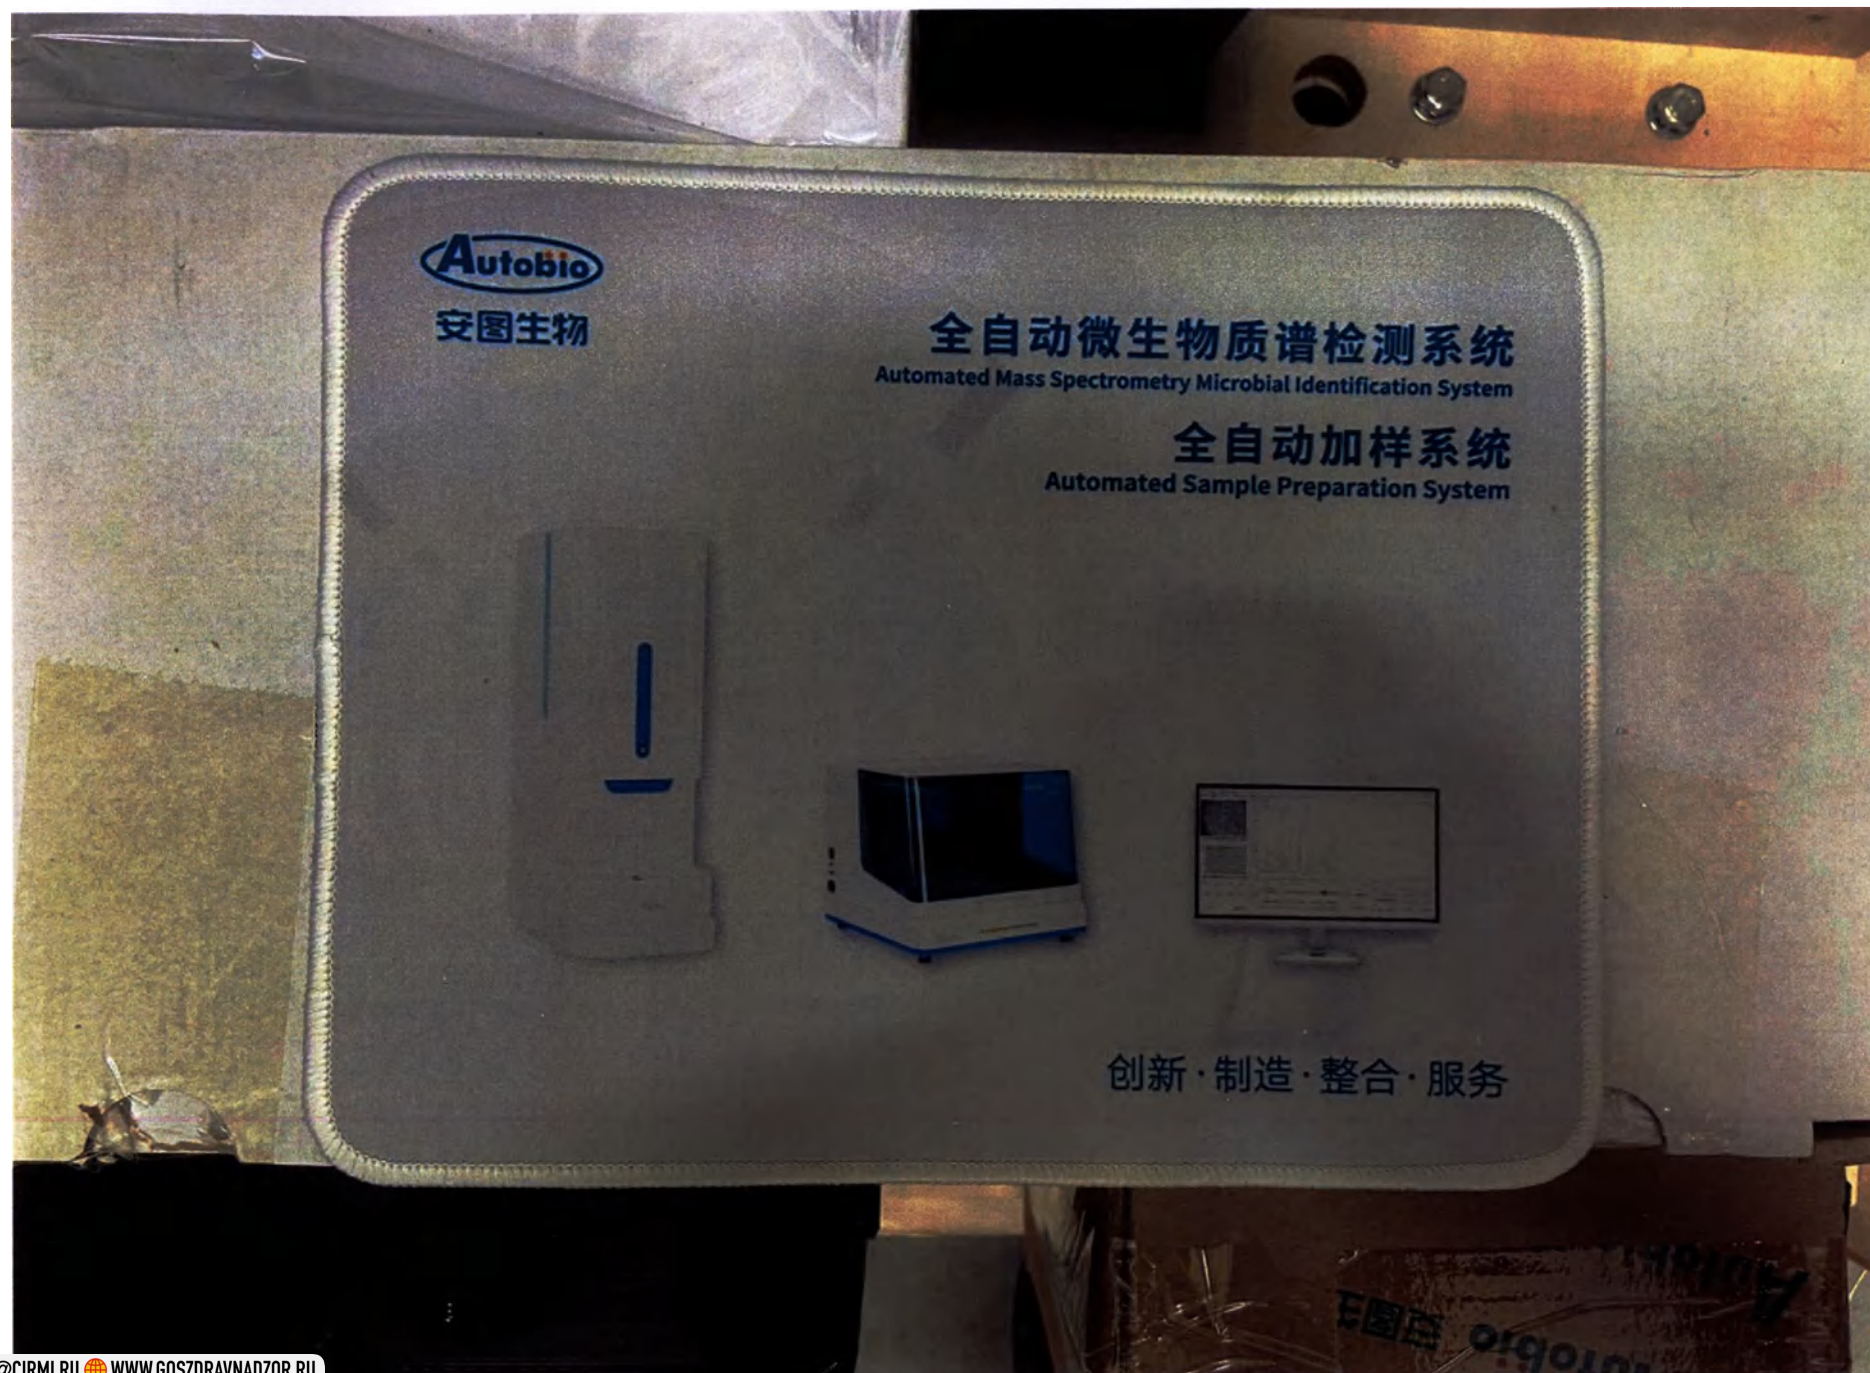




8. ЖК-дисплей (монитор)







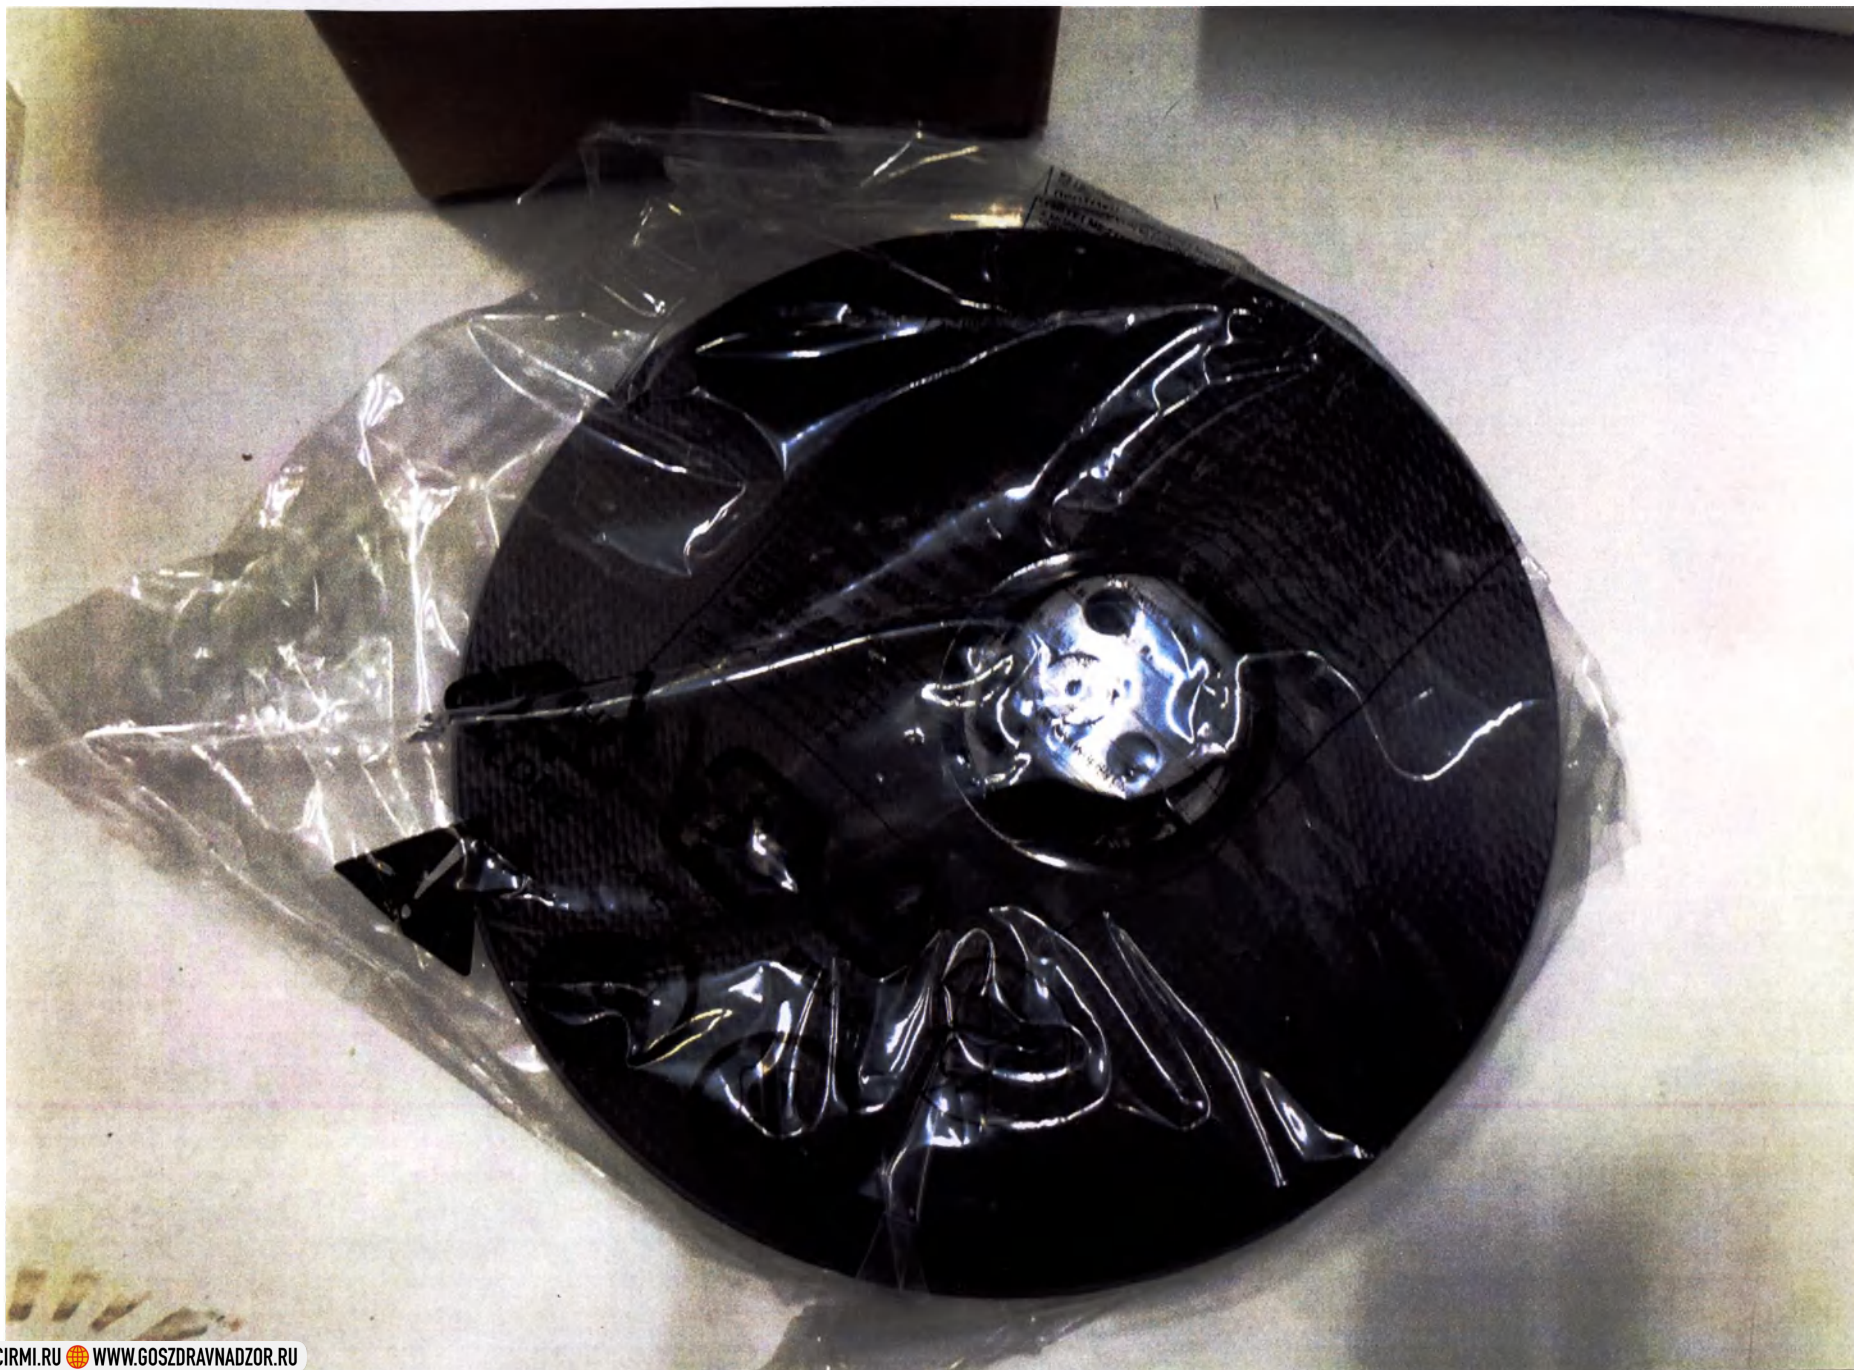

12. ПО Autof ms 1000 на CD-диске




13. Планшет для образцов – 10 шт.








16. Кабель miniDP для подключения DVI

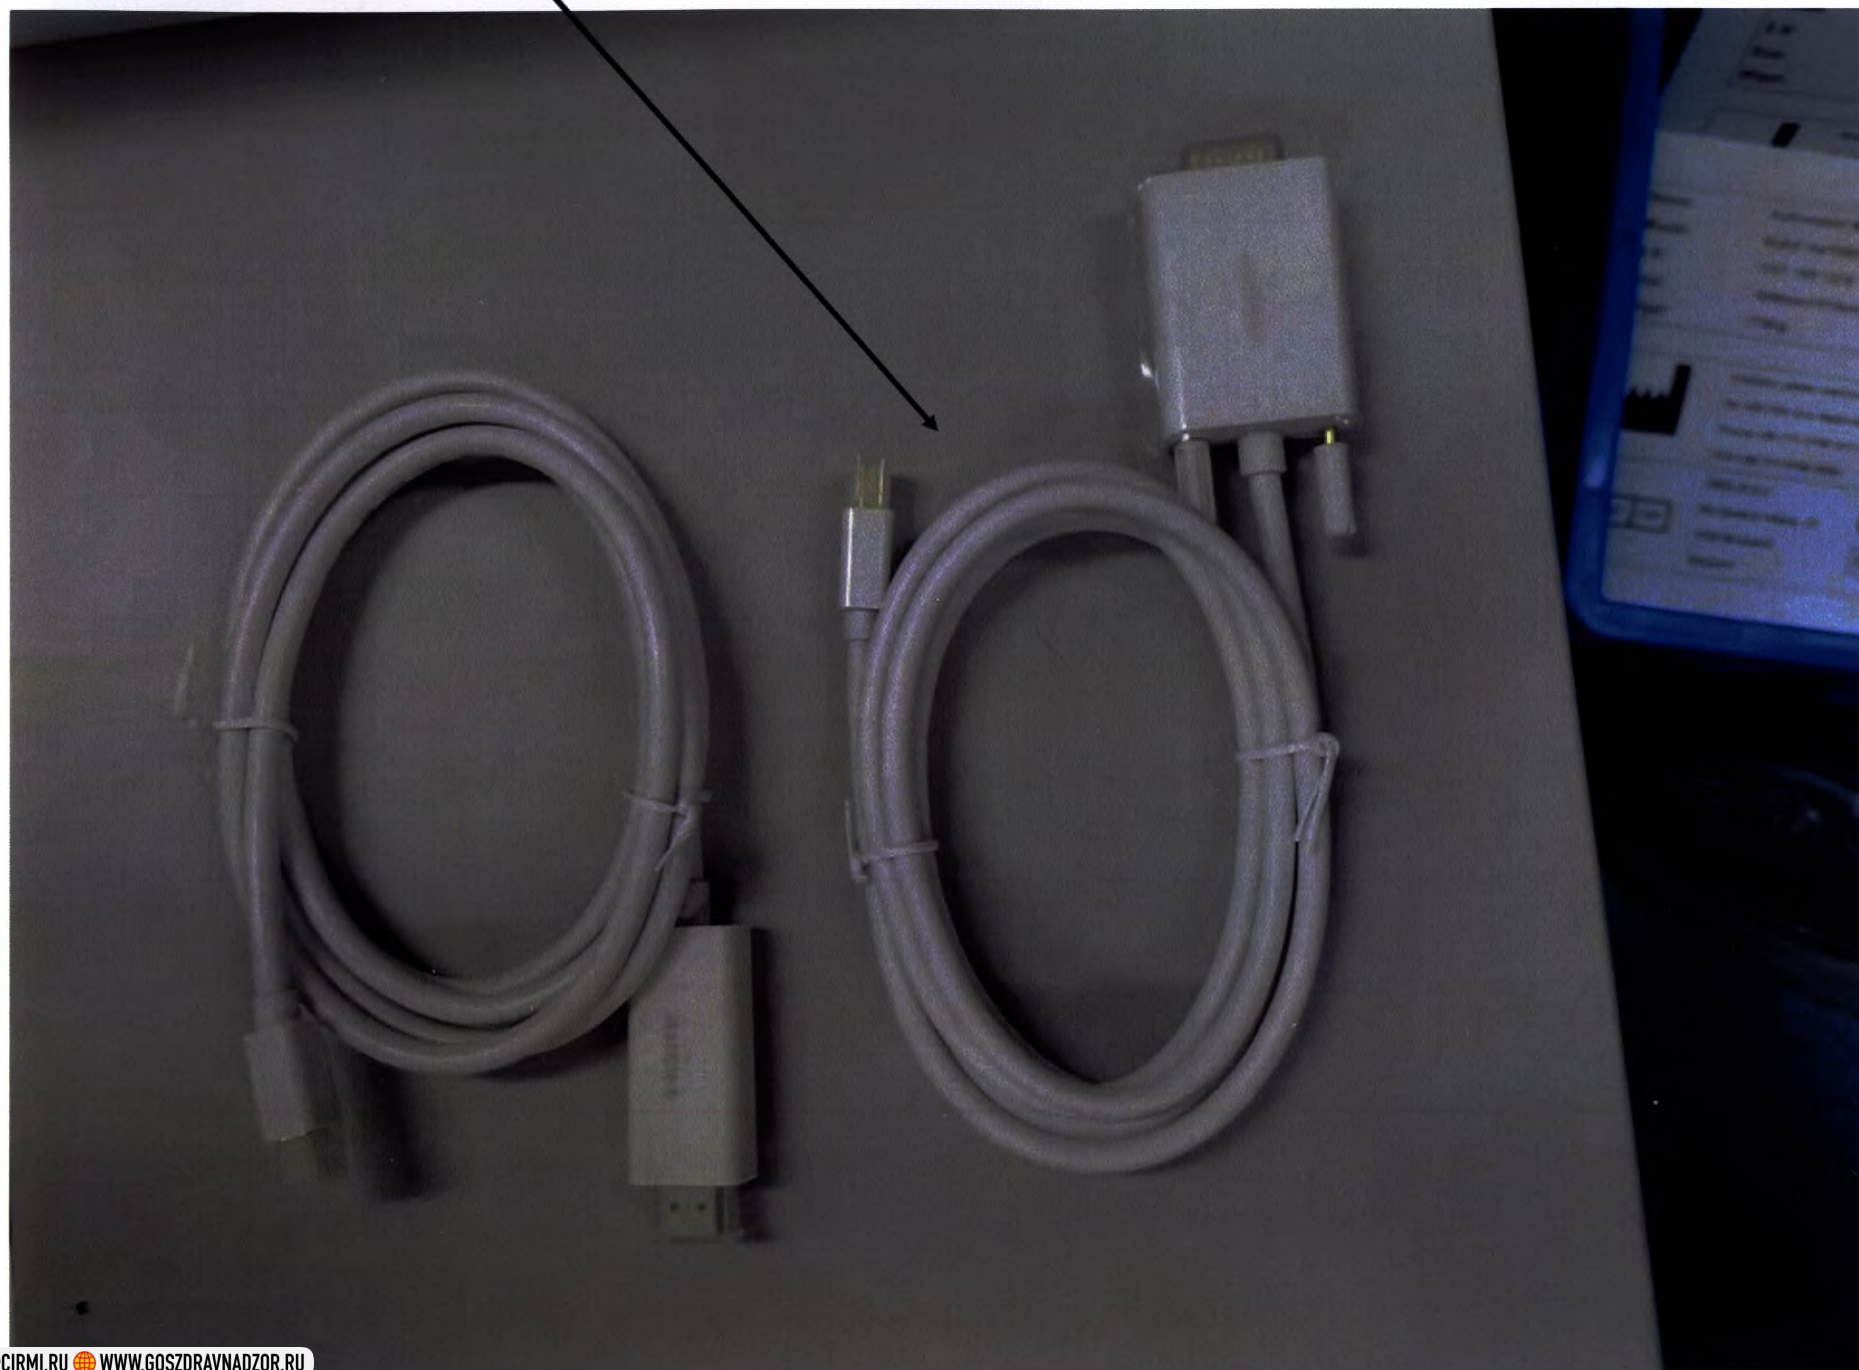


17. Кабель miniDP для подключения HDMI

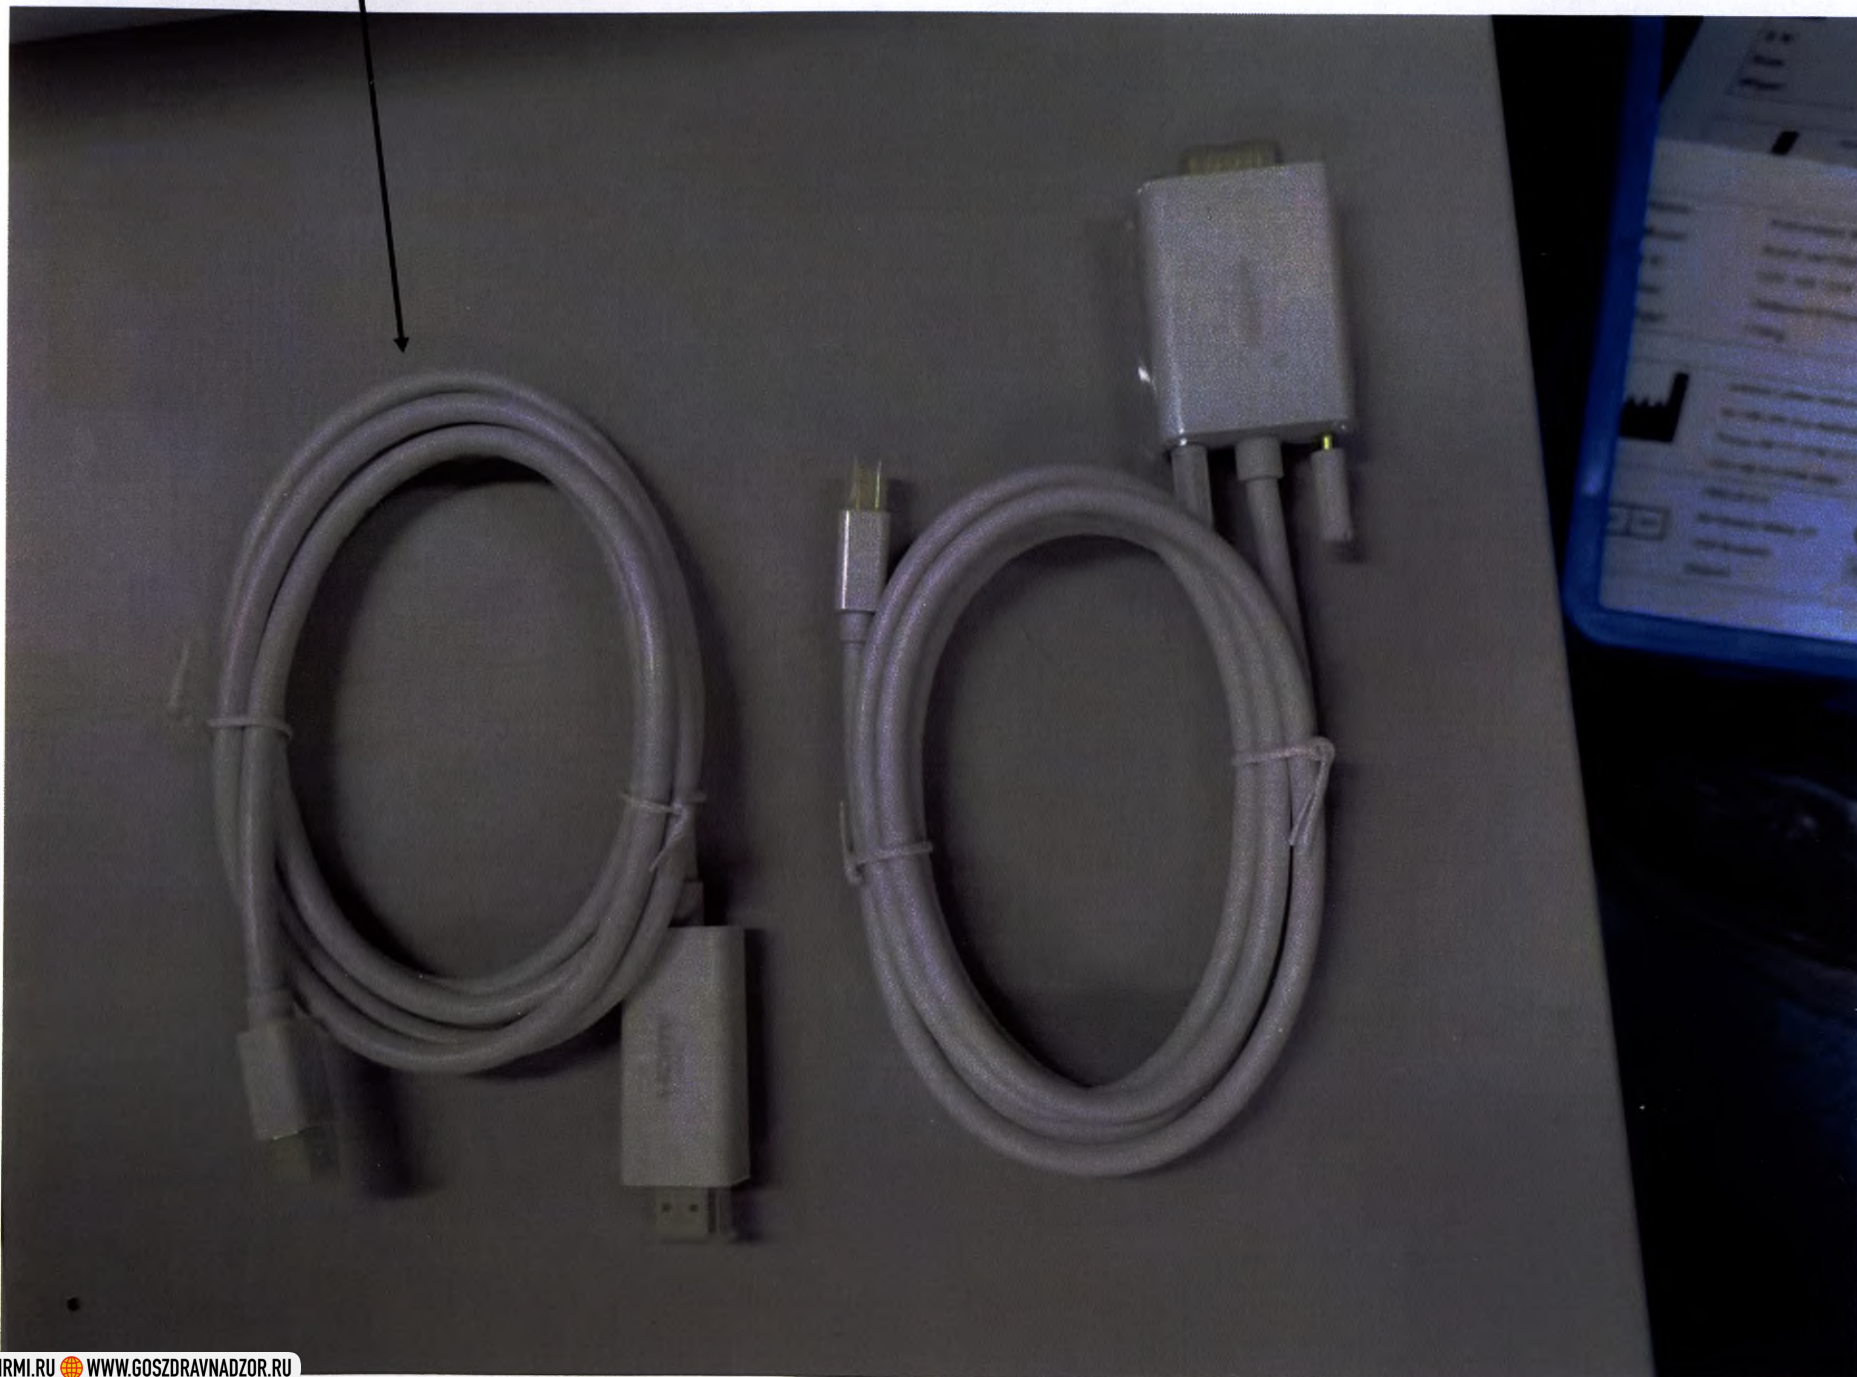


18. Внешний последовательный кабель



19. Внешний кабель обнаружения

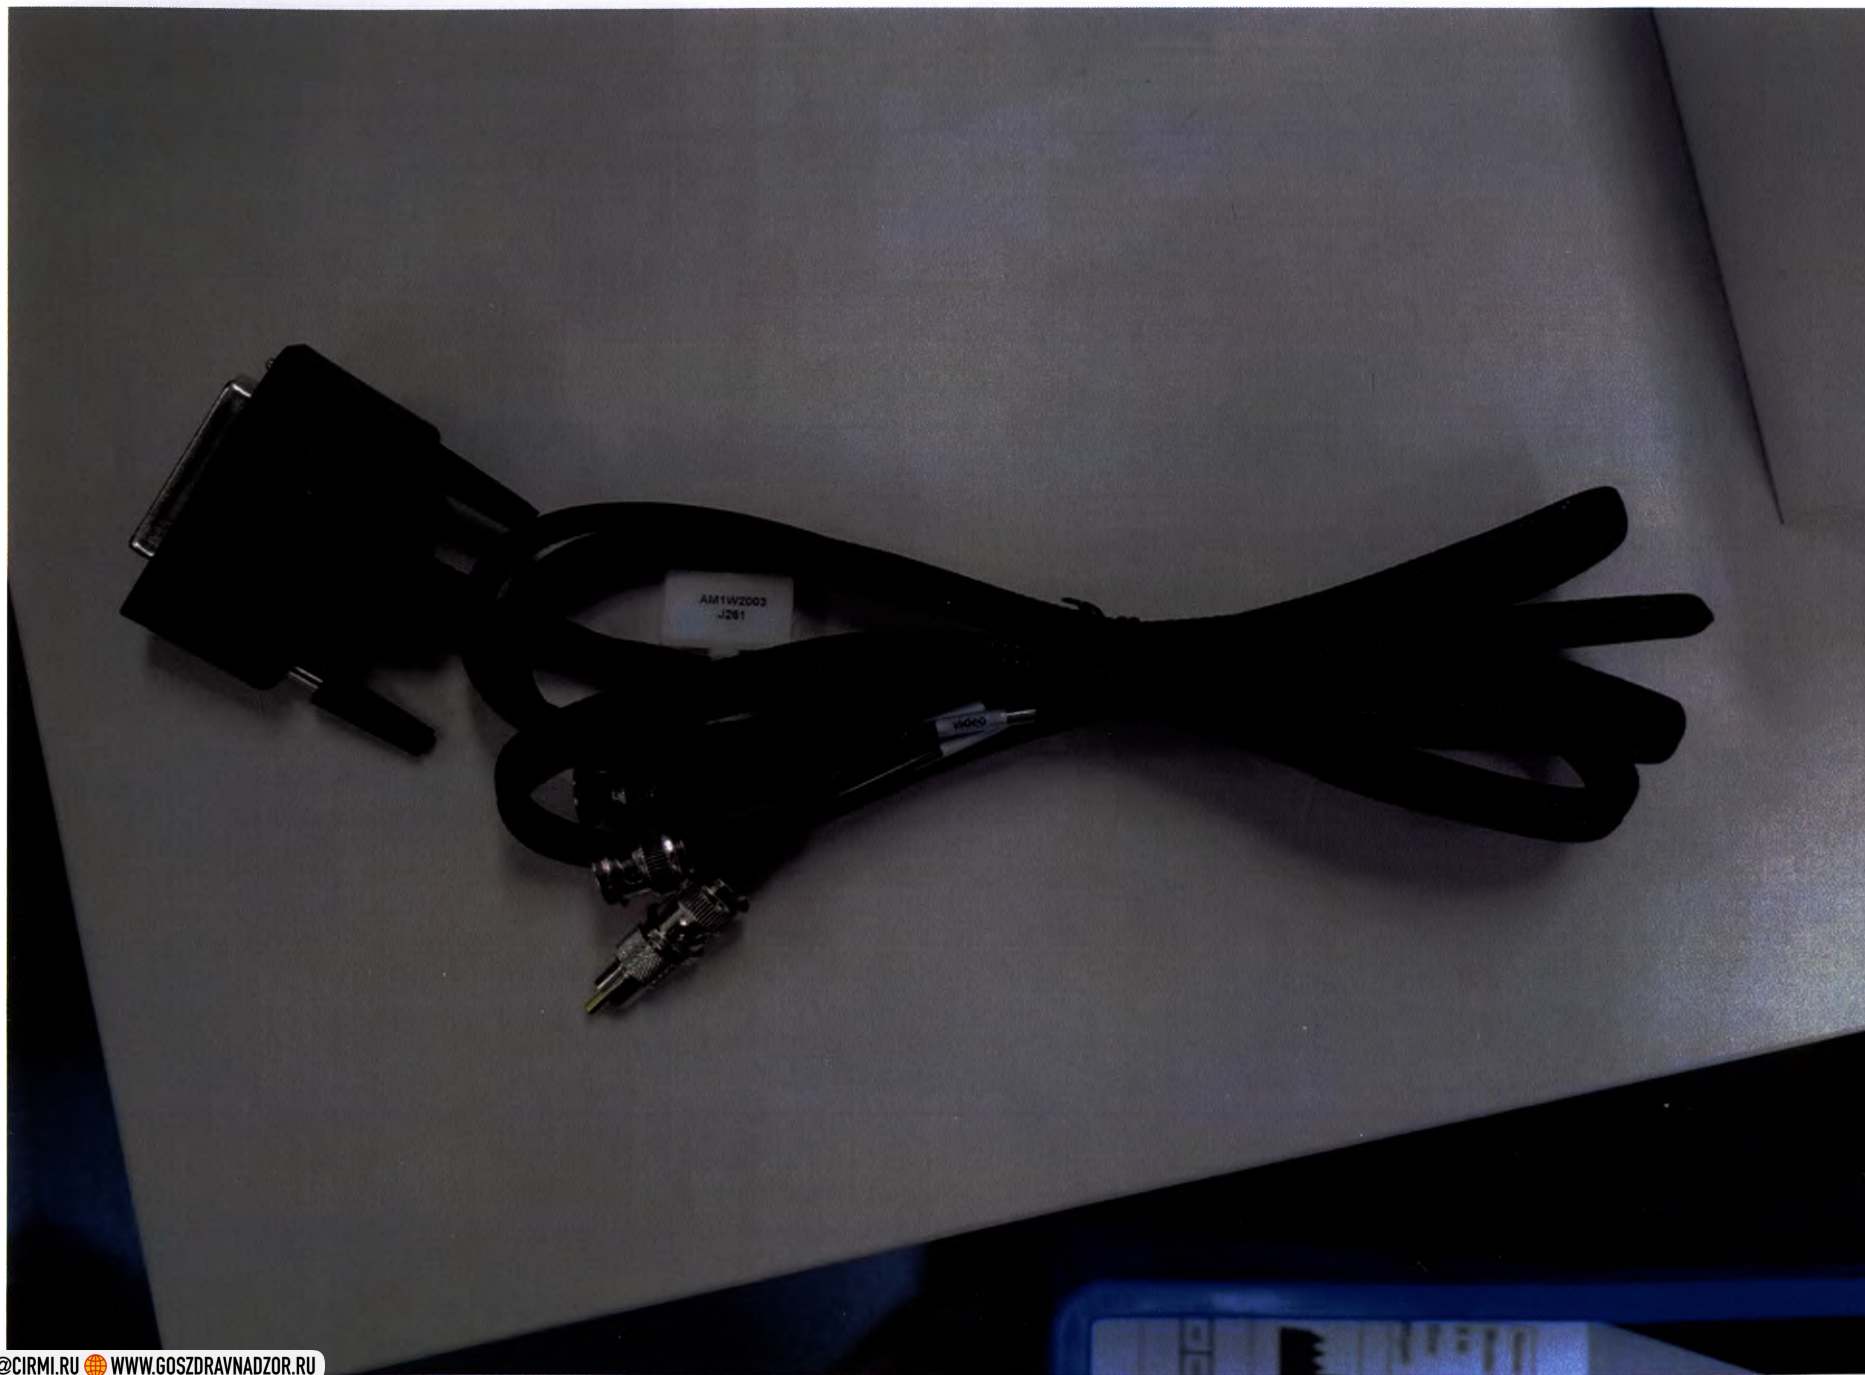

20. Кабель питания, 1,5 м

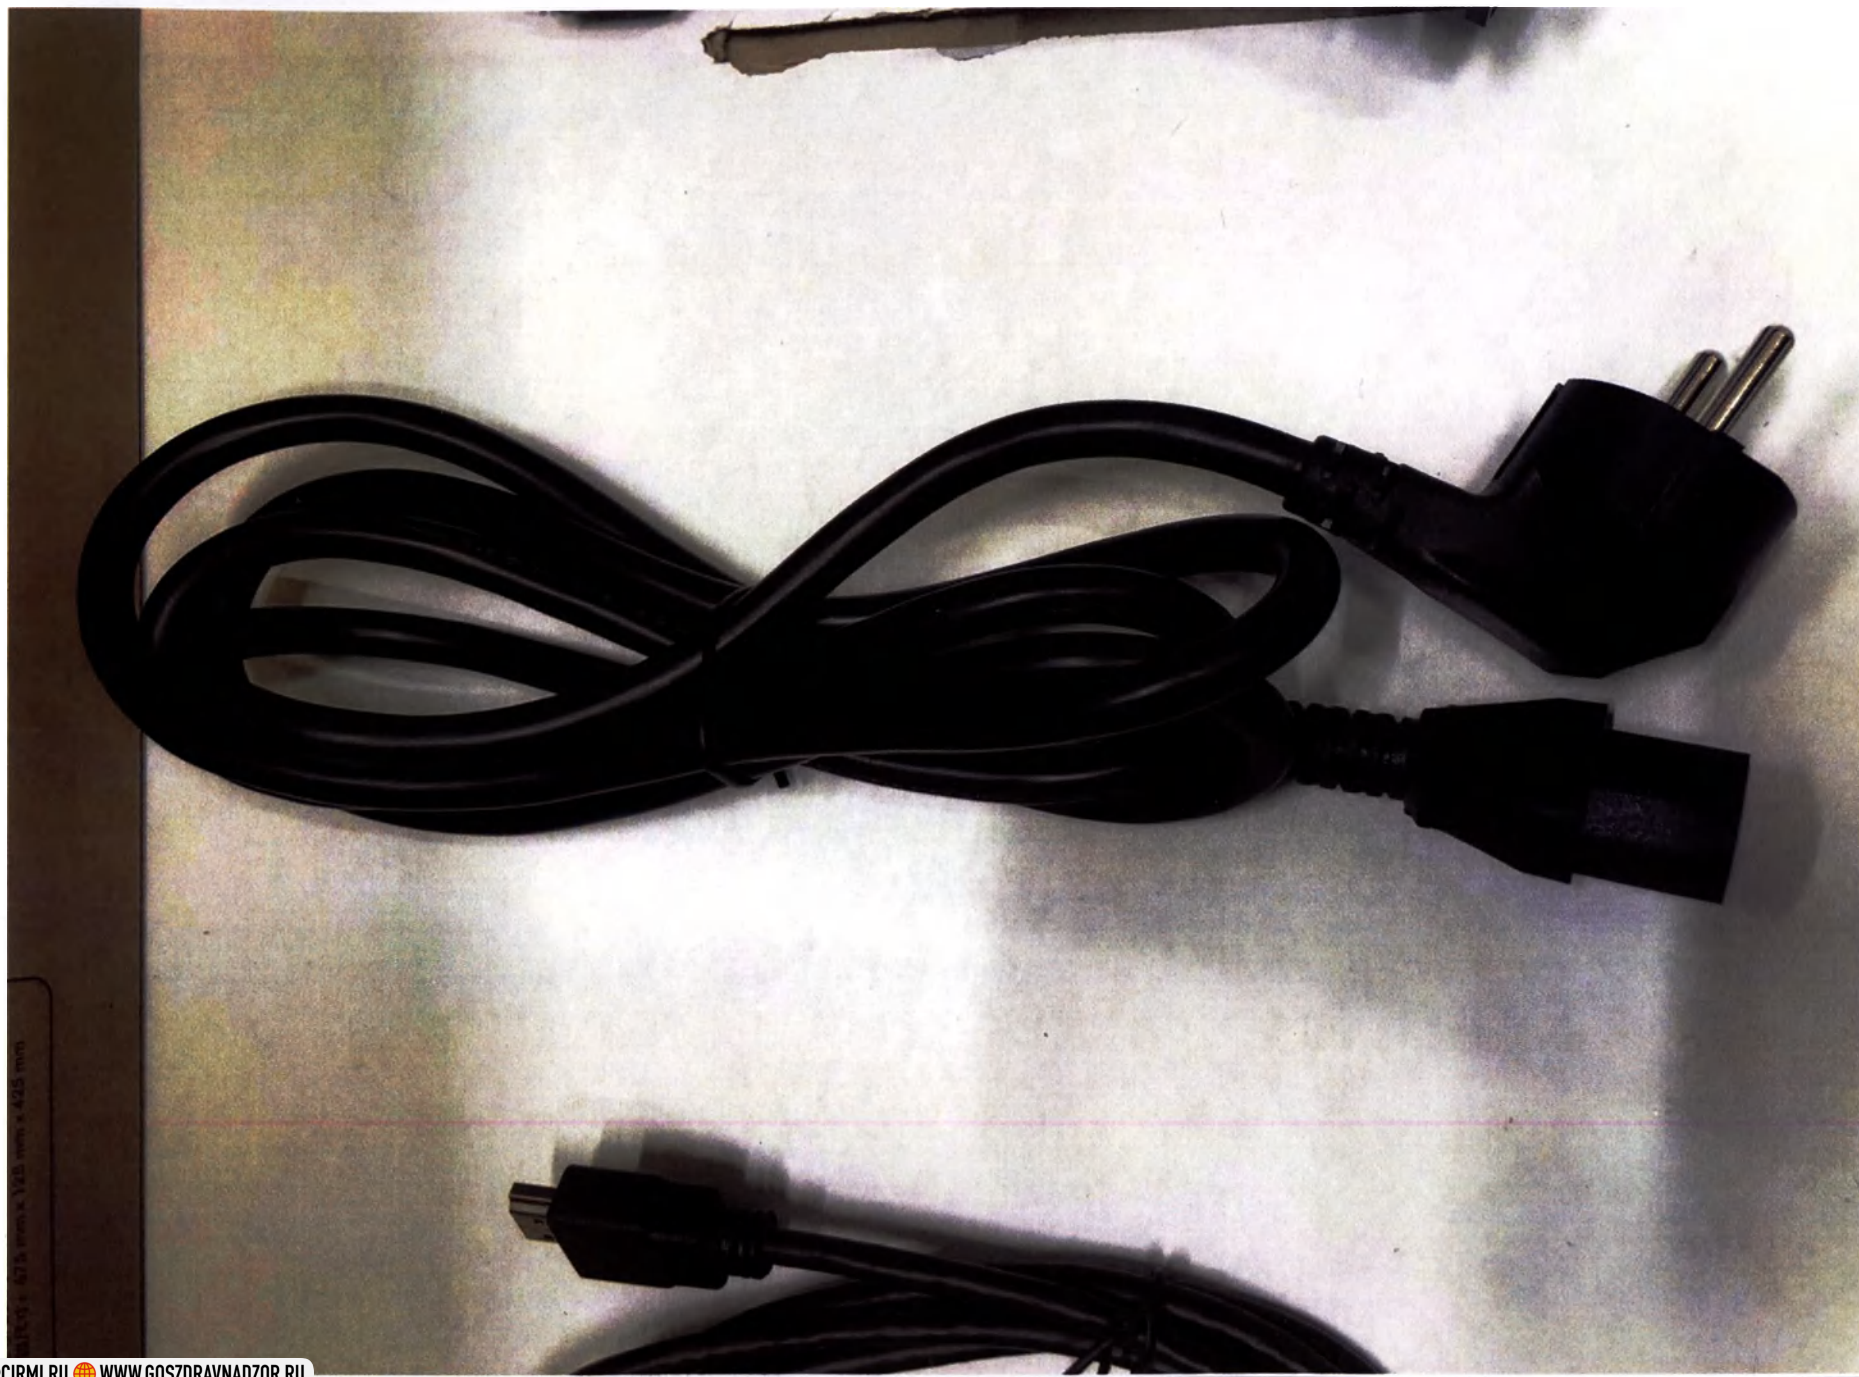




EAC

Operating Manual

AUTOOF MS1000

Automated Mass Spectrometry Microbial
Identification System


Document Version 1.2



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 29 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»



 И.А. Стариковская