

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения альбумина
в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на
биохимических анализаторах Alinity с «Микроальбумин
Реагенты для Alinity с (Microalbumin)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации,
Микроальбумин Реагенты для Alinity с (Microalbumin), вариант исполнения: 2
картриджа по 320 тестов**



08P0424



Набор реагентов для количественного определения альбумина в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Микроальбумин Реагенты для Alinity с (Microalbumin)»

Варианты исполнения: 1. 2 картриджа по 320 тестов, в составе: 1) Реагент 1 (Microalbumin R1) – 2 x 67,8 мл; 2) Реагент 2 (Microalbumin R2) – 2 x 15,6 мл; 3) Инструкция по применению – 1 шт. /
Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № ____/____ от ____/____/____ /
Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

uAlb

Microalbumin




LOT **Exp.**

uAlb

REF 08P0424  **2 x 320**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 **Exp.**


LOT

Версия

Двумерный Штрих-код

H15652R01

Уникальный идентификатор изделия (код)


R1 2 x 67.8 mL
R2 2 x 15.6 mL

Alinity c

DO NOT FREEZE

CONTAINS: AZIDE

 Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

MANUFACTURED BY

Abbott Ireland
AIDD Longford, Ireland

IVD



PRODUCT OF JAPAN

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия, Микроальбумин Реагенты для Alinity c (Microalbumin), 2 картриджа по 320 тестов

 R1 67.8 mL 2°C — 8°C DO NOT FREEZE CONTAINS: AZIDE Двумерный Штрих-код Двумерный Штрих-код ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany H15653R01 SN	uAlb Microalbumin R2 15.6 mL 08P04 CONTAINS: AZIDE Двумерный Штрих-код IVD Exp. LOT H15654R01 Abbott	H15666R01 uAlb P
--	---	-------------------------------

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов


Подпись



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения альбумина в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Микроальбумин Реагенты для Alinity с (Microalbumin)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

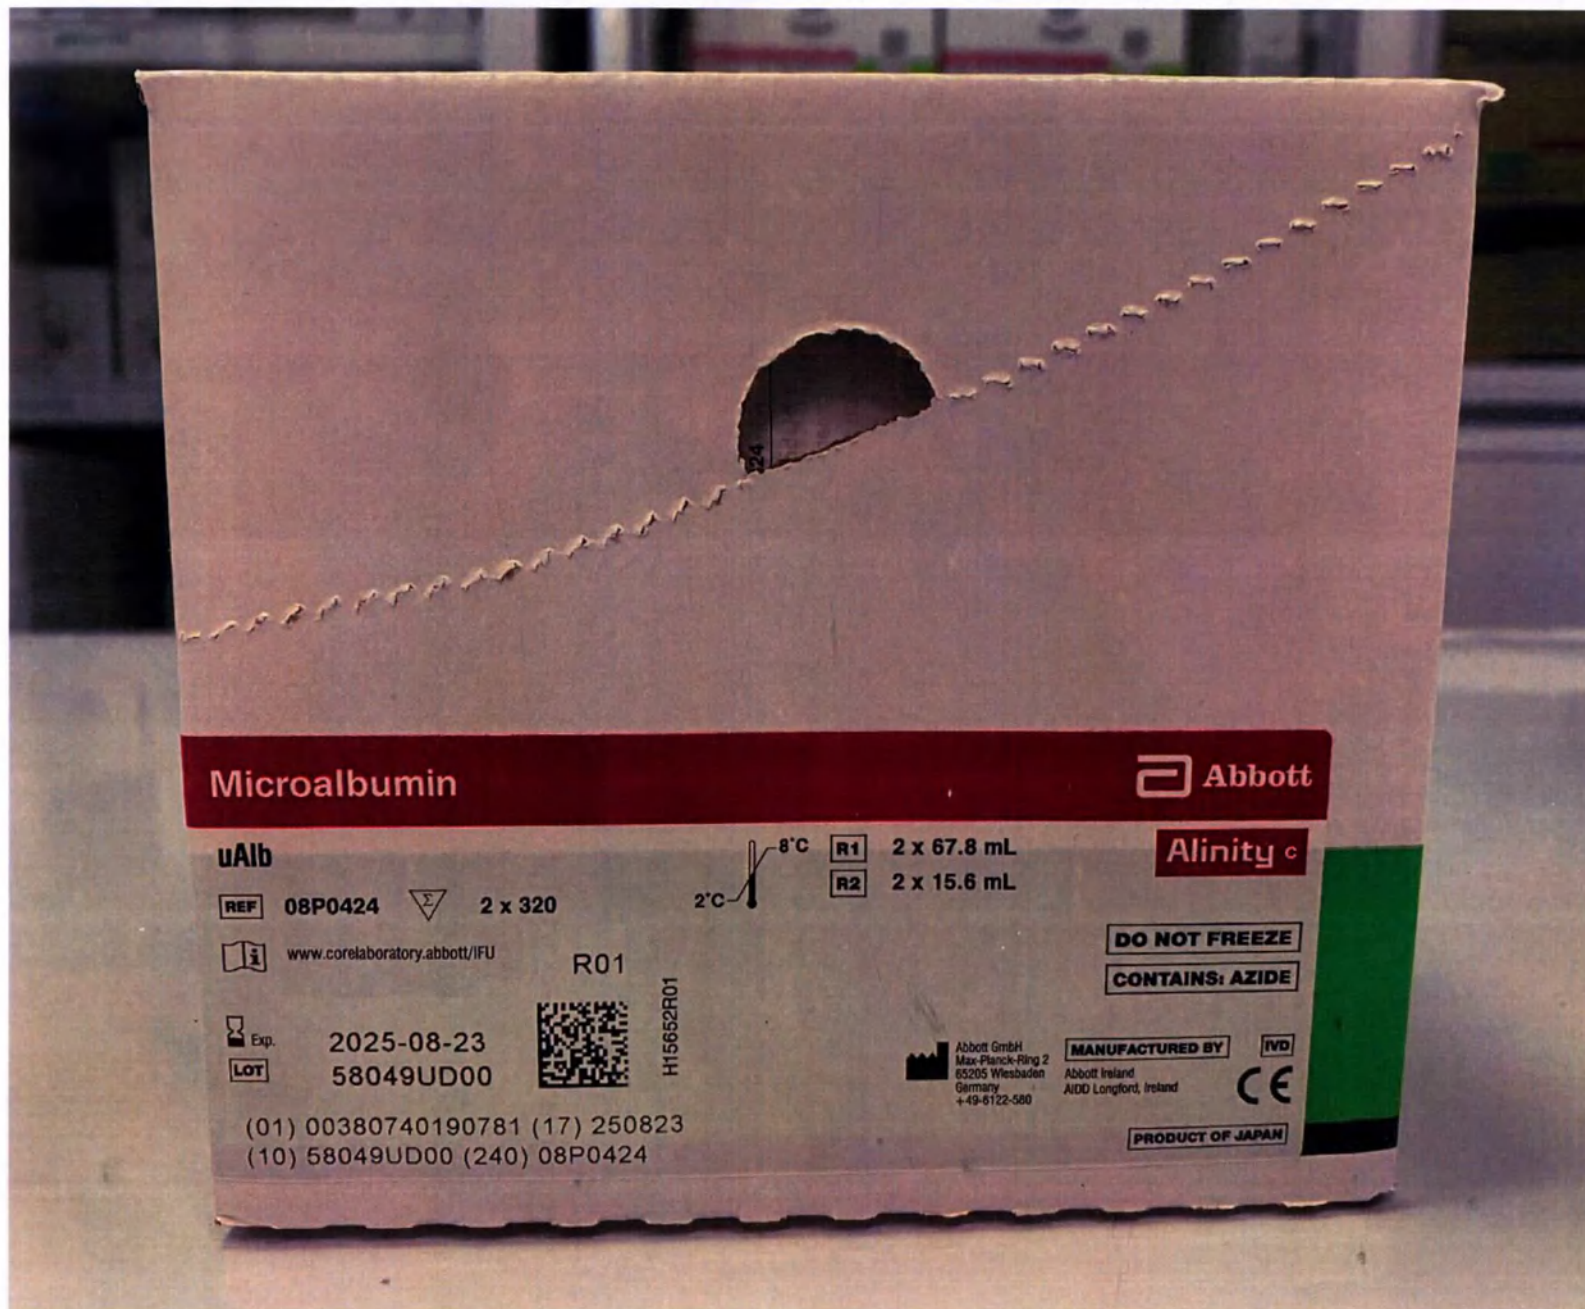

Фотографическое изображение вида упаковки сбоку Микроальбумин Реагенты для Alinity с (Microalbumin)







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



Подпись _____