


Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности
количественного определения альбумина в моче человека
иммунотурбидиметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity c «Микроальбумин Калибраторы для
Alinity c (Microalbumin Calibrators)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации
Микроальбумин Калибраторы для Alinity с (Microalbumin Calibrators)**



08P0404



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения альбумина в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Микроальбумин Калибраторы для Alinity с (Microalbumin Calibrators)»


В составе: 1) Калибратор 1 (Microalbumin Calibrators CAL 1) – 1 флакон х 2,0 мл; 2) Калибратор 2 (Microalbumin Calibrators CAL 2) – 1 флакон х 2,0 мл; 3) Калибратор 3 (Microalbumin Calibrators CAL 3) – 1 флакон х 2,0 мл; 4) Калибратор 4 (Microalbumin Calibrators CAL 4) – 1 флакон х 2,0 мл; 5) Калибратор 5 (Microalbumin Calibrators CAL 5) – 1 флакон х 2,0 мл; 6) Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81



Microalb Cals

Alinity c

PRODUCT OF JAPAN

Abbott GmbH
Max-Planck-Str. 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49 61 72-680

MANUFACTURED BY
Abbott Ireland
Abbott Longford, Ireland

CE

IVD

INFORMATION FOR USA ONLY

For use in the calibration of the Microalbumin assay on the Alinity c system.

The **CAL 1-5** contain human serum albumin. Preservative: sodium azide (0.09%). Infection Risk.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Microalbumin Calibrators

 **Abbott**

Microalb Cals

		CONC µg/mL mg/L
CAL 1	1 x 2.0 mL	5
CAL 2	1 x 2.0 mL	25
CAL 3	1 x 2.0 mL	100
CAL 4	1 x 2.0 mL	300
CAL 5	1 x 2.0 mL	500



CONTAINS: AZIDE


DO NOT FREEZE

 www.corelaboratory.com/IFU

REF 08P0404

 Exp.

LOT



Версия

Двумерный Штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

H15656R01

Маркировка компонентов медицинского изделия Микроальбумин Калибраторы для Alinity c (Microalbumin Calibrators)

- Калибратор 1 (Microalbumin Calibrators CAL 1)



- Калибратор 2 (Microalbumin Calibrators CAL 2)



- Калибратор 3 (Microalbumin Calibrators CAL 3)



- Калибратор 4 (Microalbumin Calibrators CAL 4)



- Калибратор 5 (Microalbumin Calibrators CAL 5)



Всего прошито, пронумеро
и скреплено печатью

____ листов

Подпись _____




**Фотографические изображения общего вида на медицинское
изделие**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения альбумина в моче человека
иммунотурбидиметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity c «Микроальбумин Калибраторы для
Alinity c (Microalbumin Calibrators)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



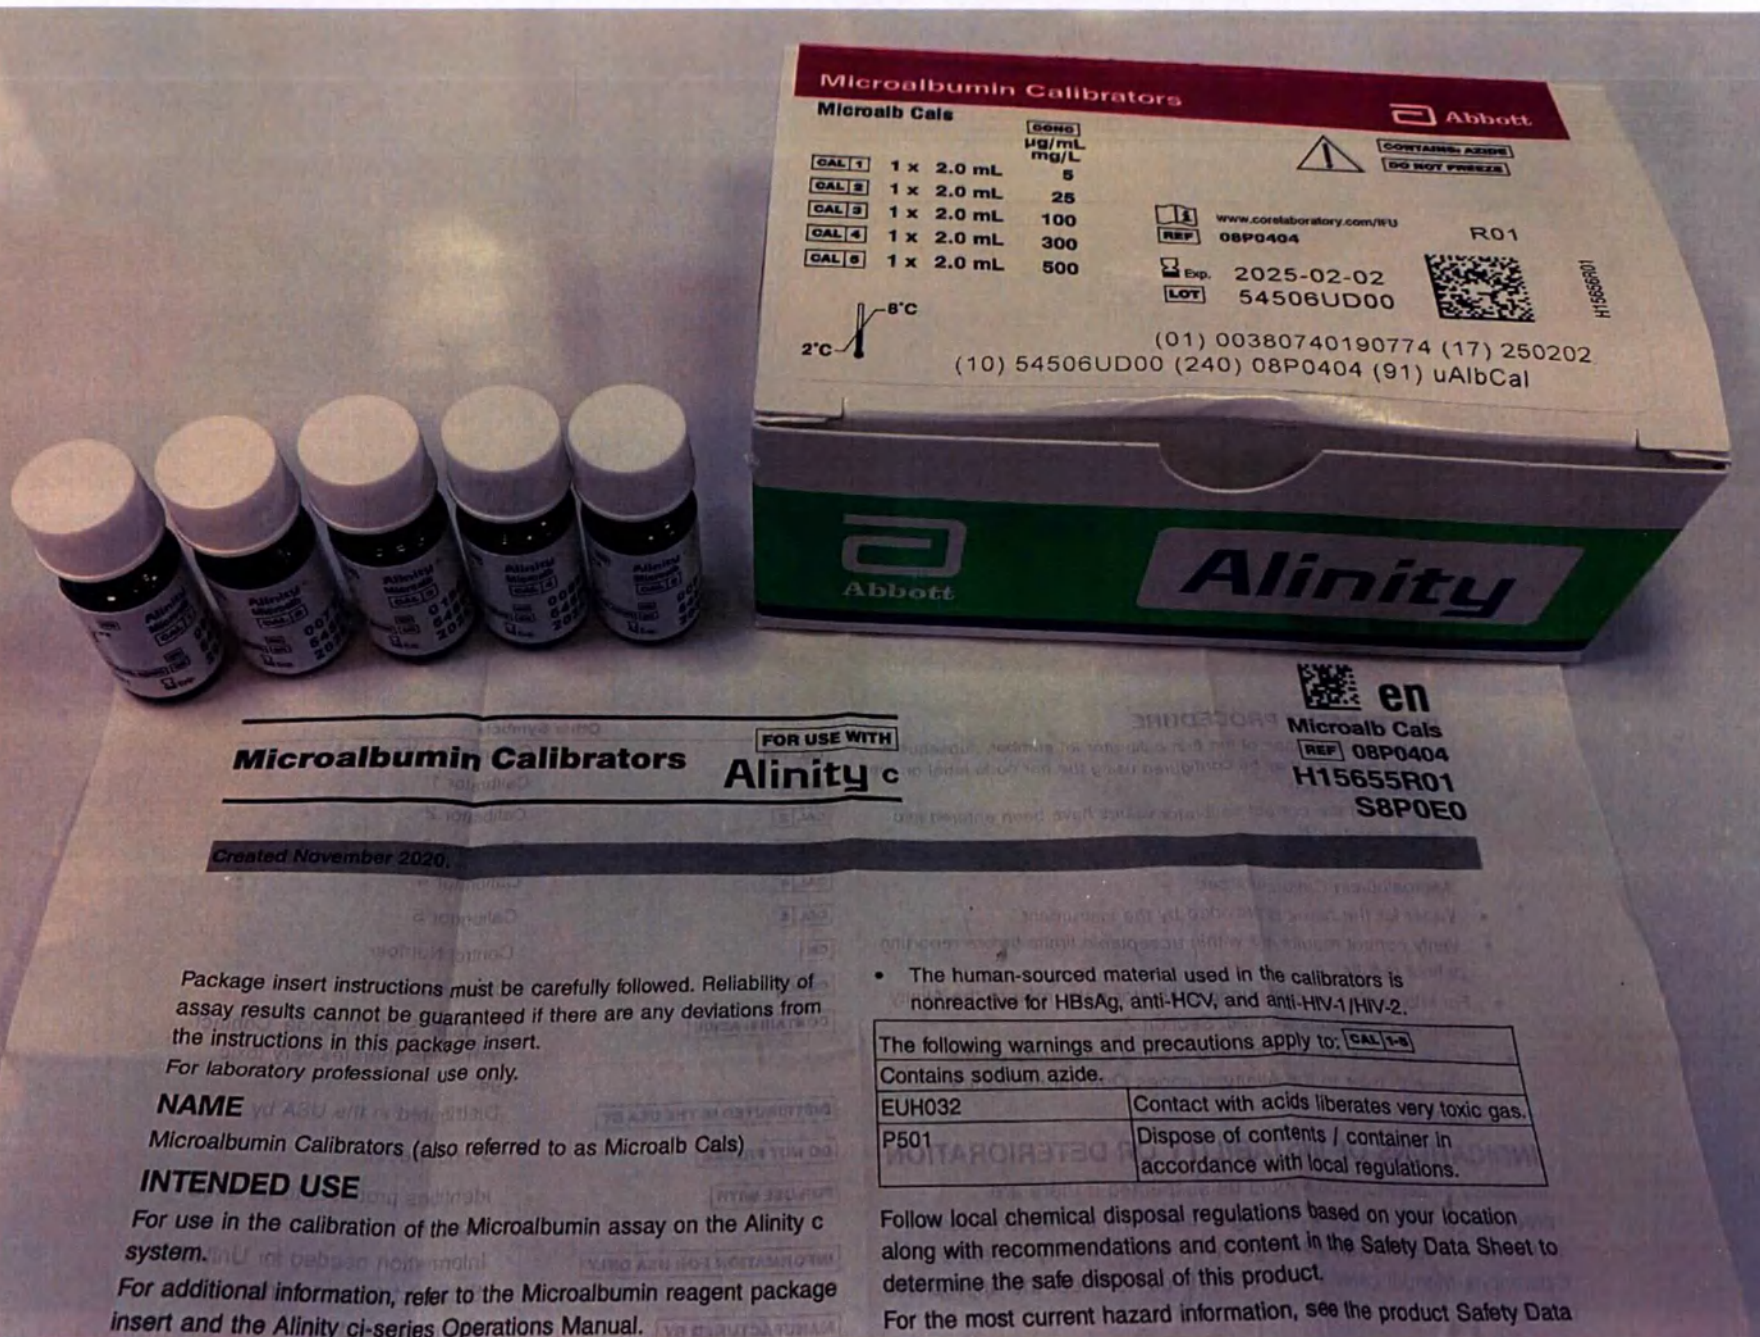

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов

Подпись _____

