



Установка для гипокситерапии
четырёхместная с индивидуальным
заданием и индикацией программ
дыхания

“БИО-НОВА-204”

ТУ 9444-001-40059061-98

ООО “НТО “БИО-НОВА”

Россия, 125167, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ
Аэропорт, ул. 1-я 8 марта, д. 3,
помещ. 1Ц

~220В 50Гц 800Ватт

Зав. № **0000** 2024г.



Копия верна
Директор
ООО "НТО "БИО-НОВА"
Борисов Н.Н.



Газоразделительный блок


 Установка для гипокситерапии
 четырёхместная с индивидуальным
 заданием и индикацией программ
 дыхания


“БИО-НОВА-204”
 ТУ 9444-001-40059061-98
 ООО “НТО “БИО-НОВА”
 Россия, 125167, г. Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ
 Аэропорт, ул. 1-я 8 марта, д. 3,
 помещ. 1Ц

 ИМО2


 ~220В 50Гц 800Ватт
 Зав. № 0000 2024г.




Маркировка

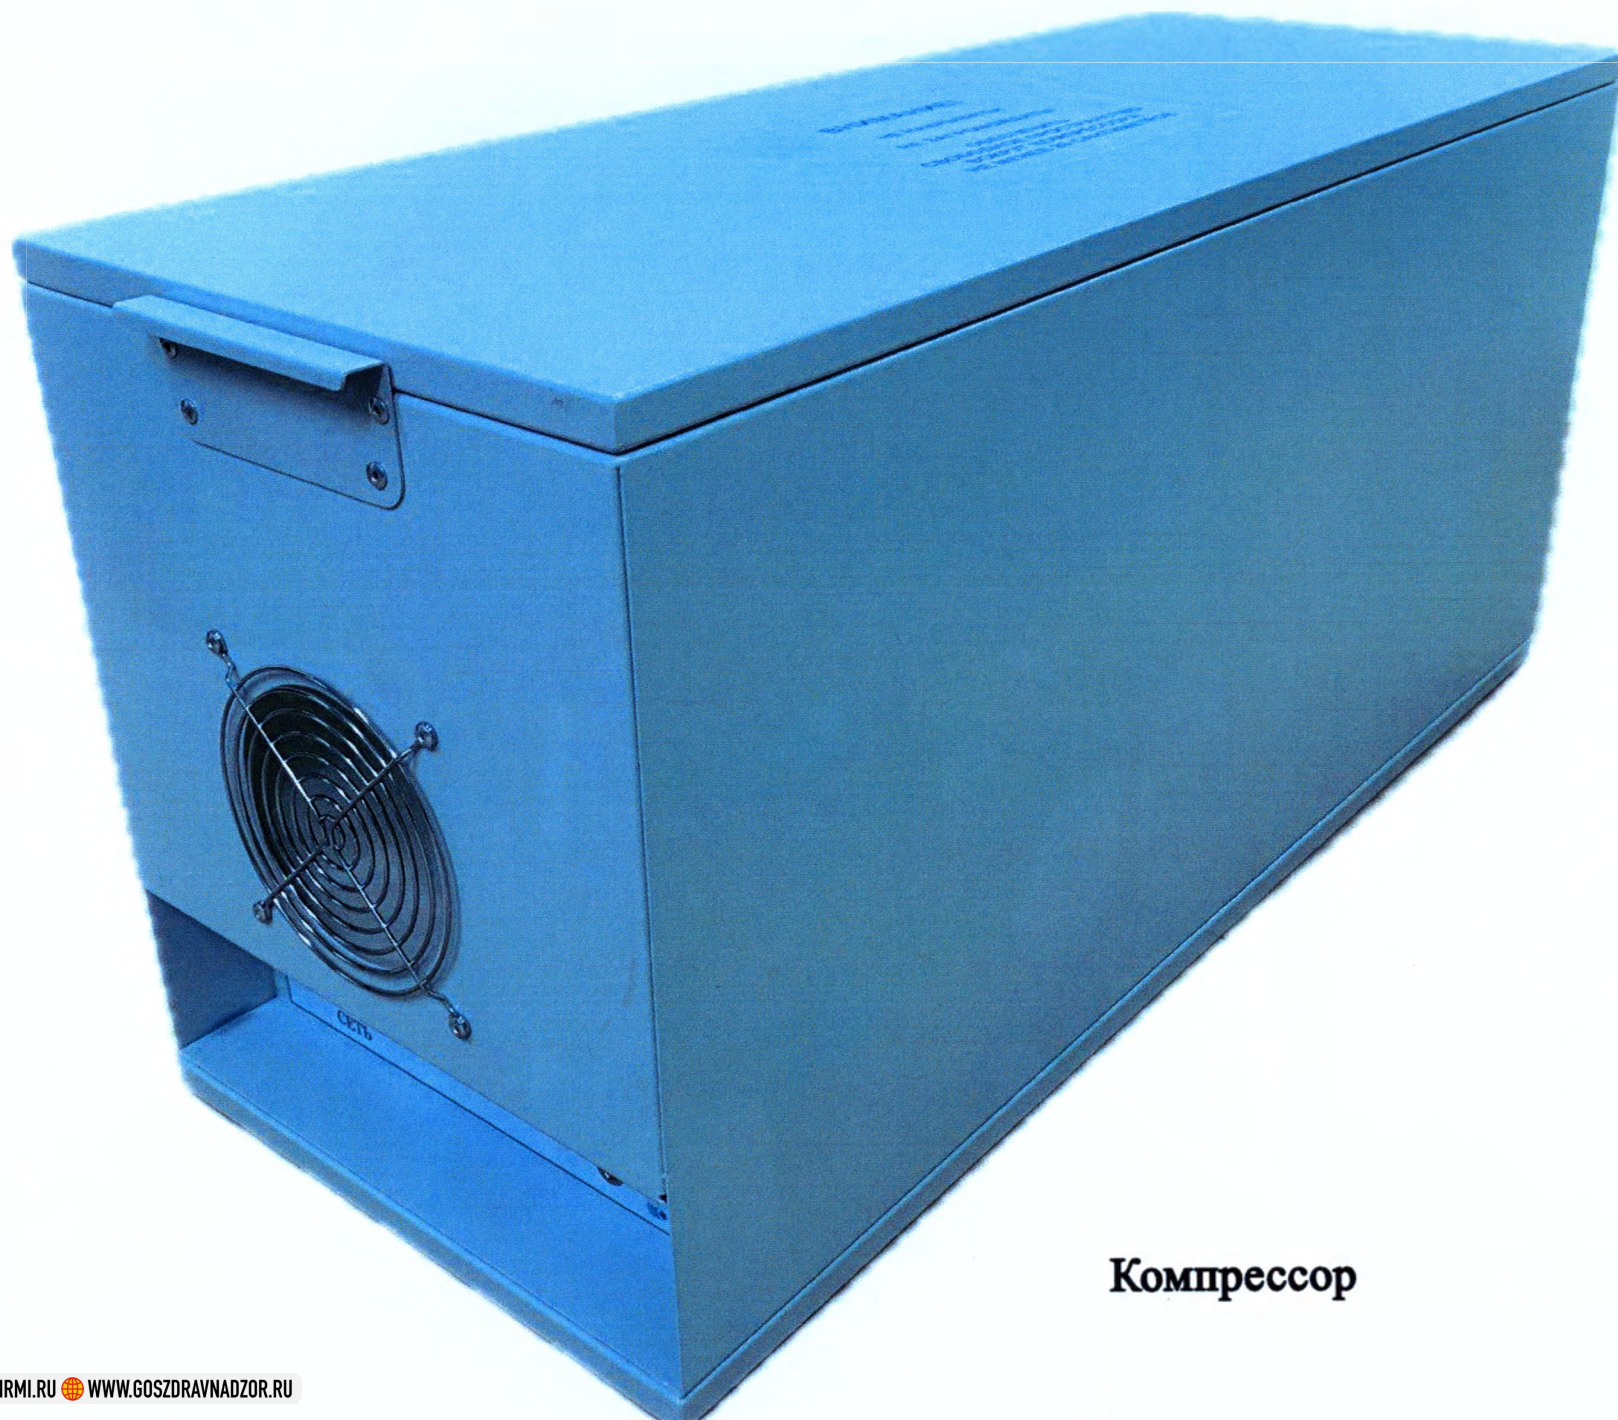

Компрессор



Терминал пациентов

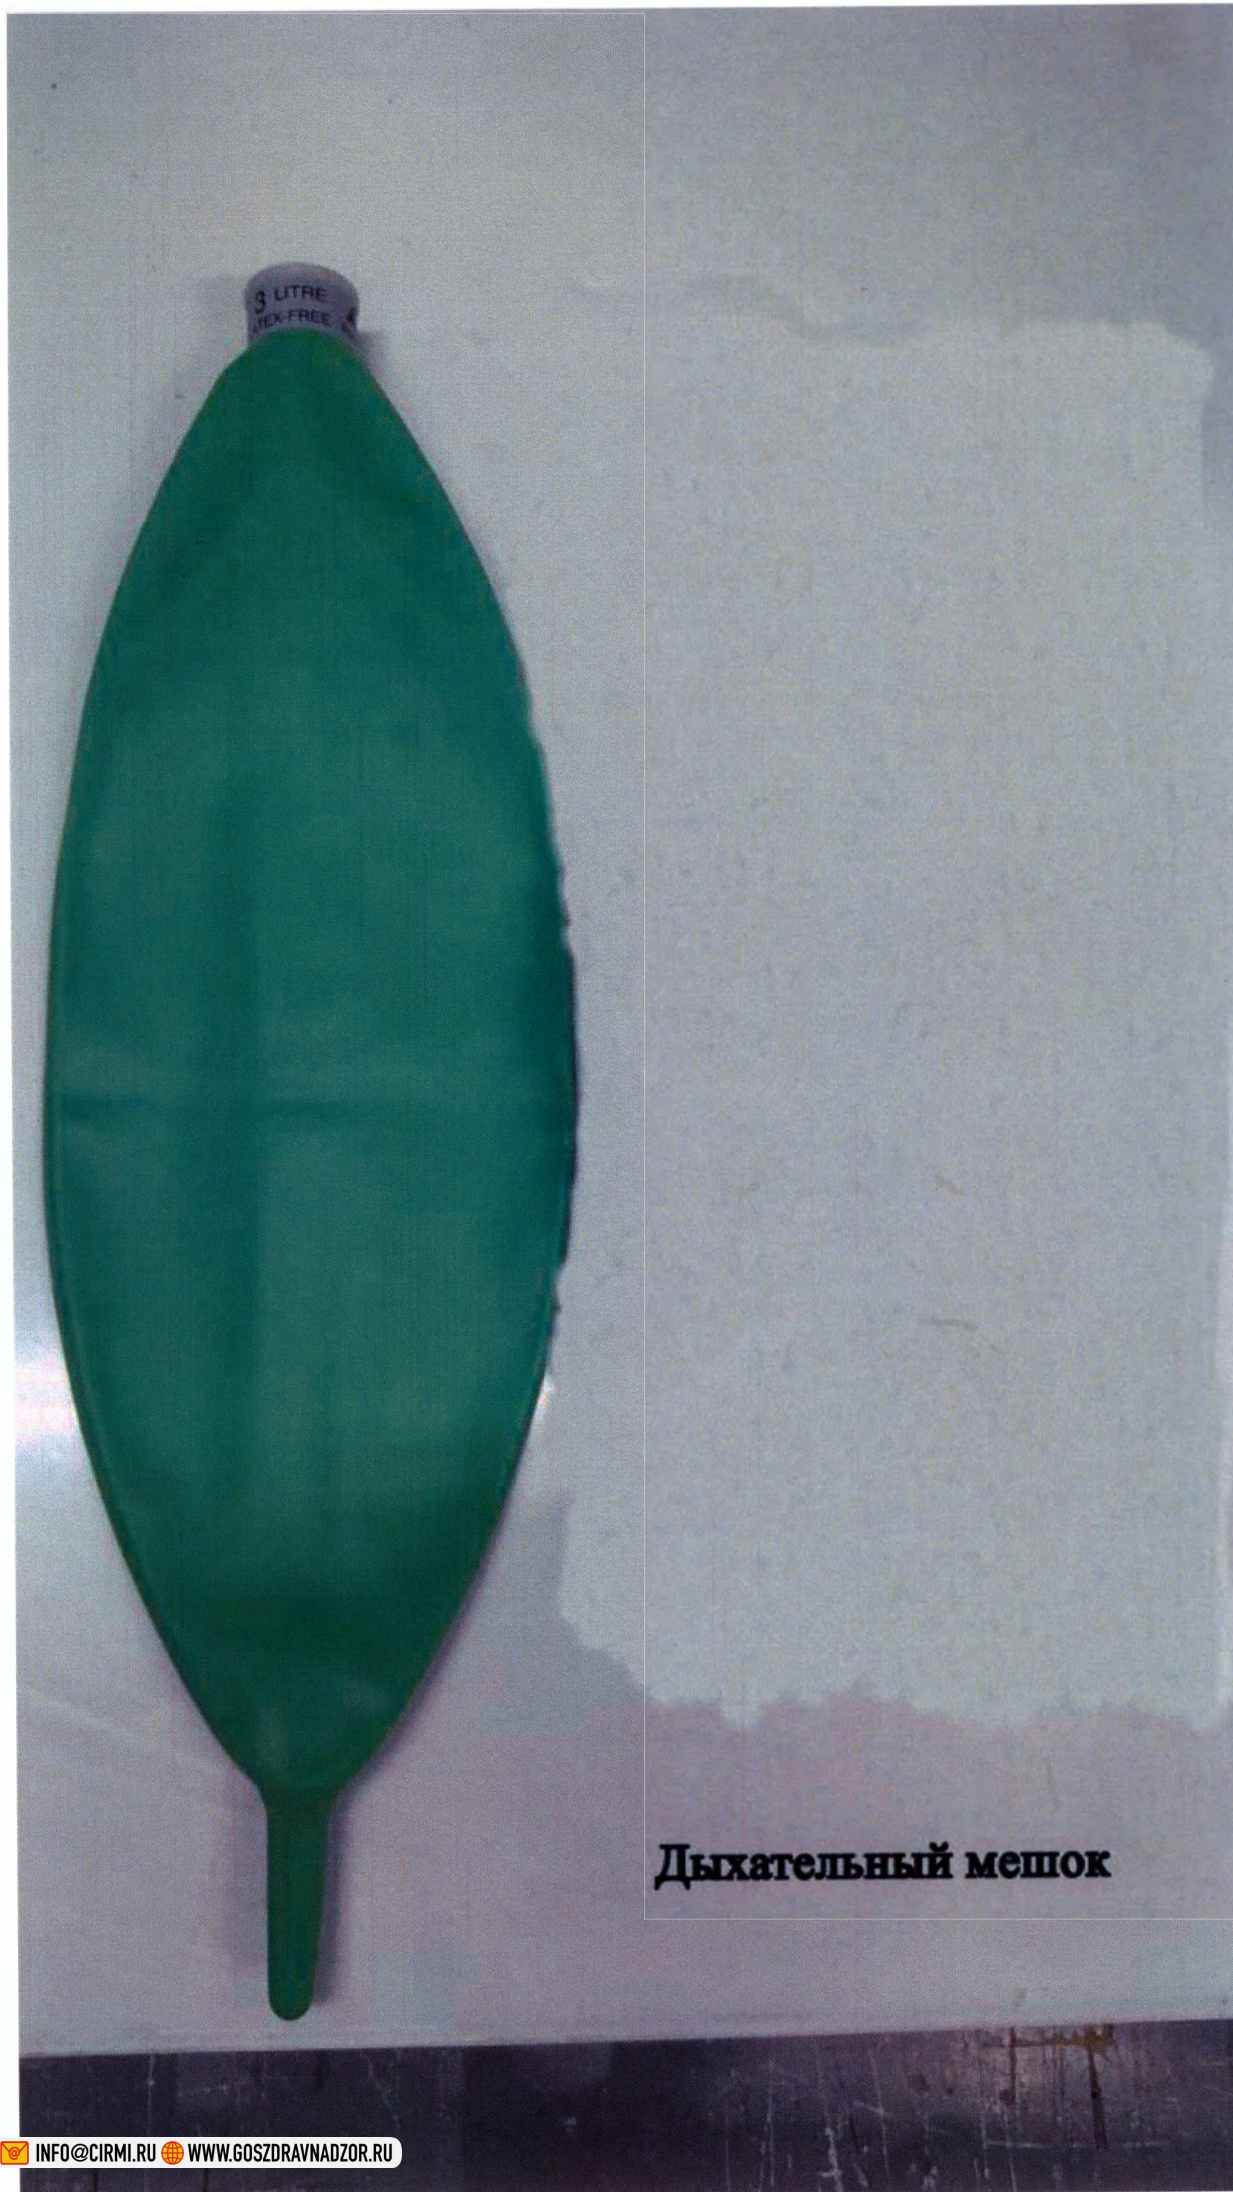

Дыхательный мешок



COVIDIEN™
DAR™
Anesthesia Mask
Inflatable
5
Masque d'anesthésie
Gonflable

REF 8806
LOT 22D0318FAX
Use by 2027-04-01

NO FLAME
Rx ONLY
CAUTION

Not made with natural rubber latex
Not made with DEHP
Single use
Do not use if package is opened or damaged


MR unsafe 0123

© 2011 Covidien. Made in Italy.
Covidien Inc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.
Covidien Ireland Limited, (DA Business & Technology Park, Tullamore, 10137950 Rev A


(01)20884522033494
(17)270401
(10)22D0318FAX



Маска лицевая

Клапан вдоха-выдоха

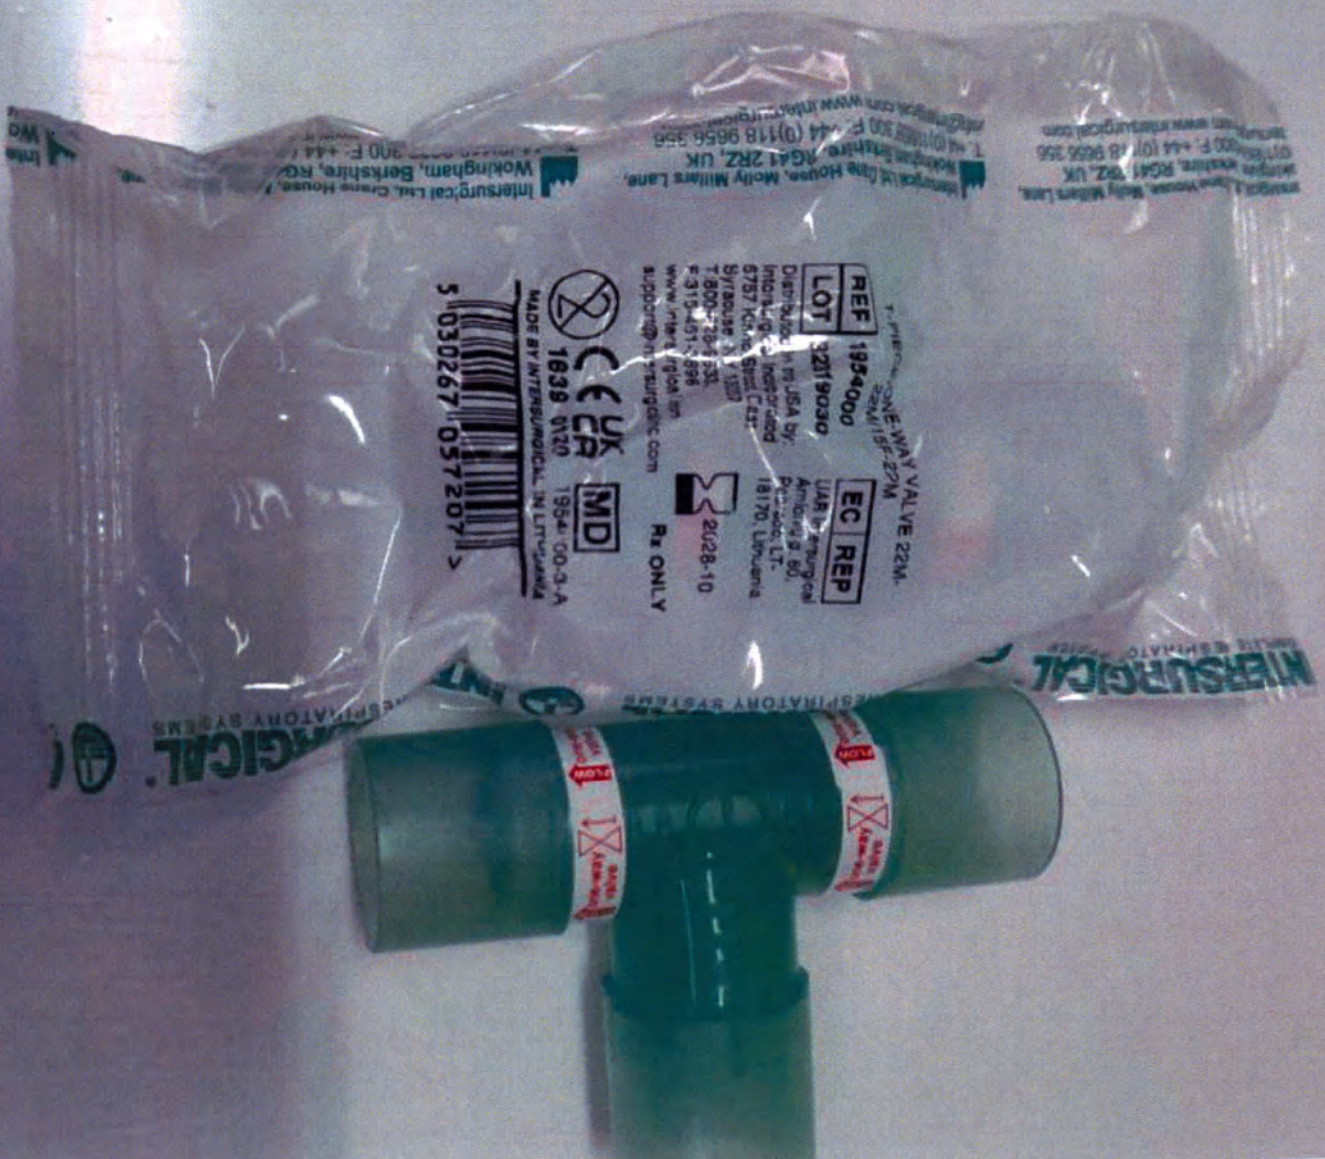

Коннектор

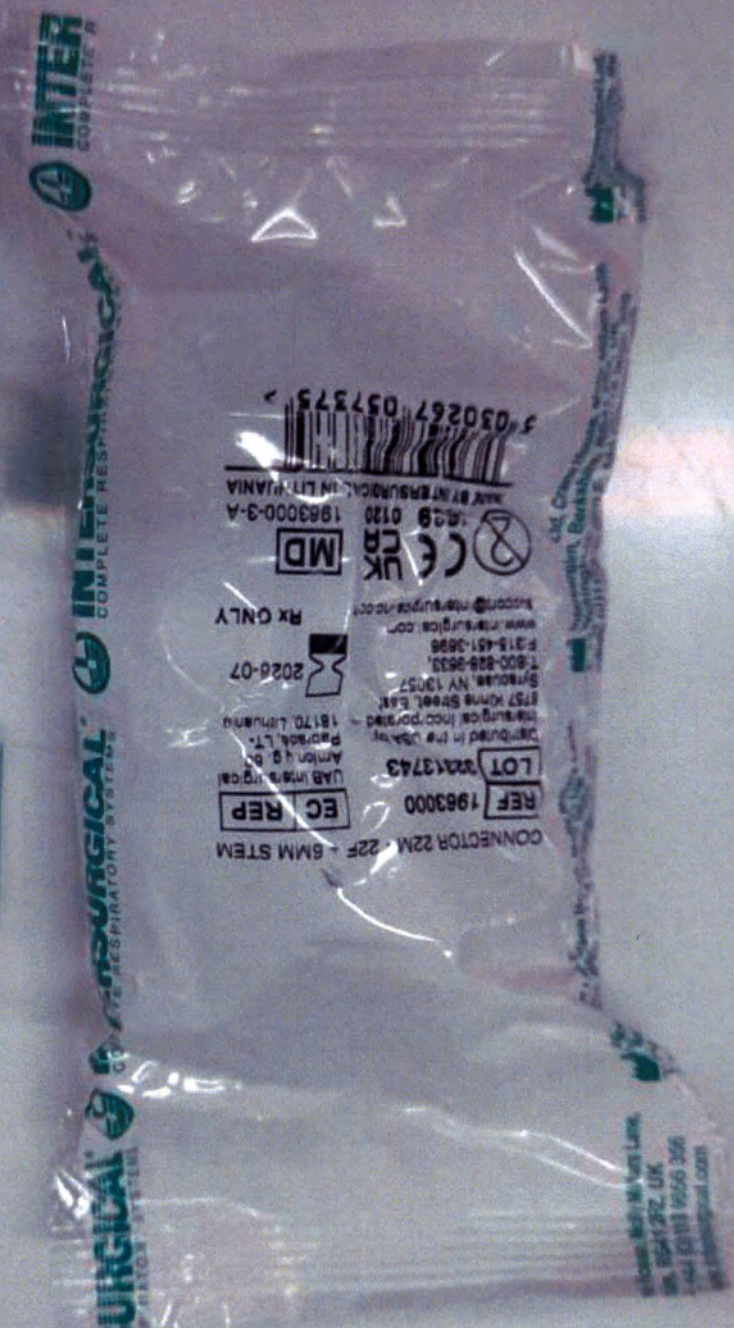

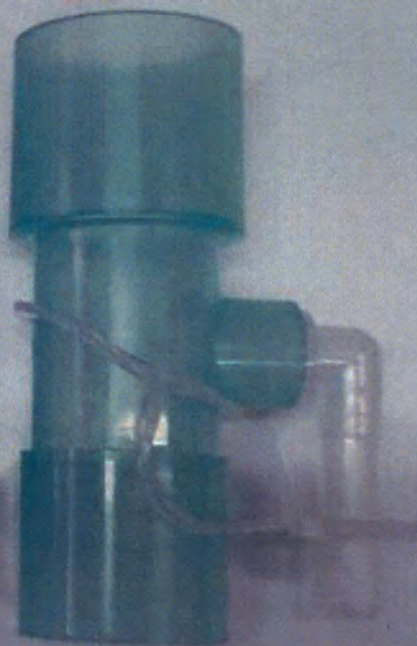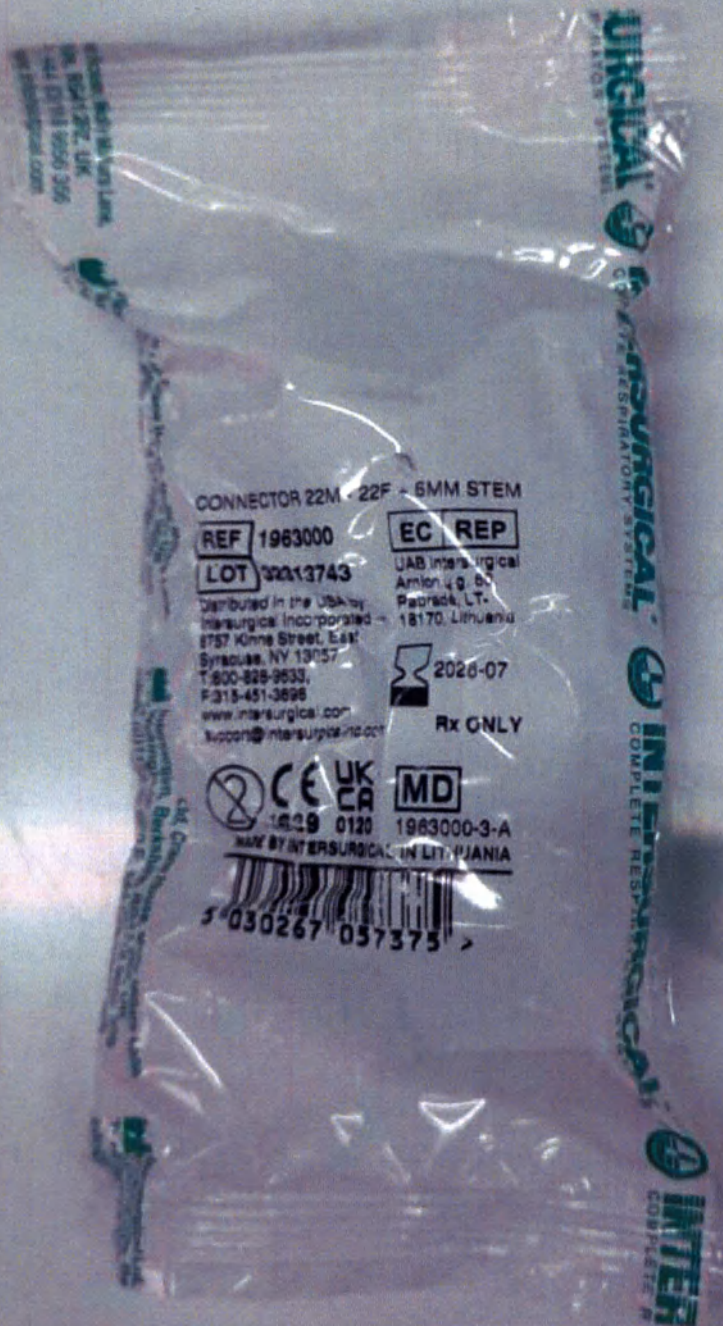

Коннектор

Paclan


D. VĂRZARU

1000 ШТук

[illegible]

Material
 description
 in Russian
 LDPE
 HDPE
 FHL
 018
 018


ООО ЦРПИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAYNADZOR.RU

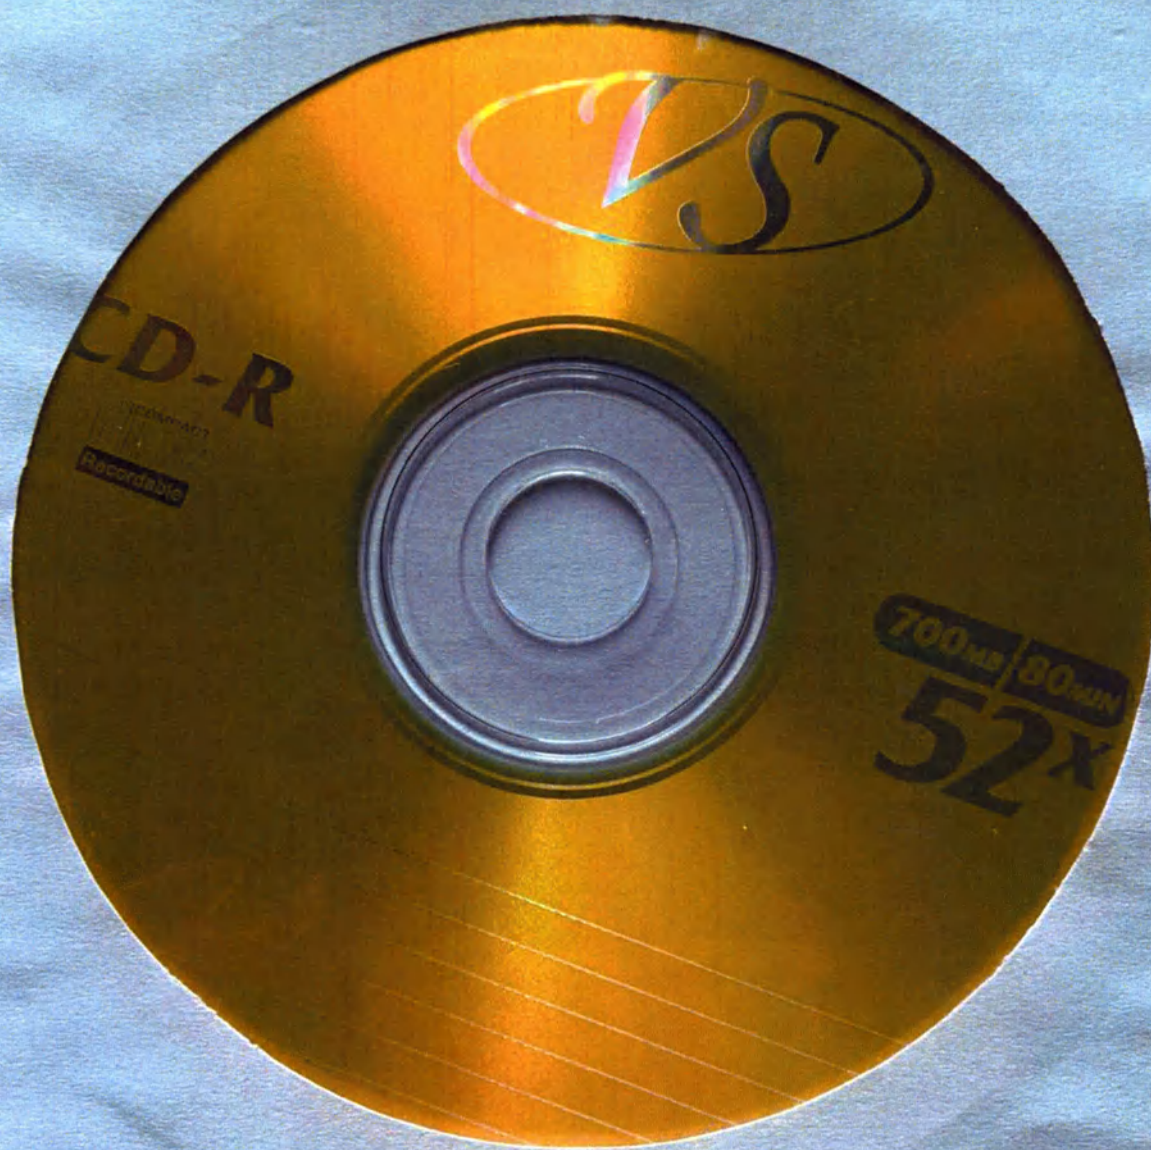

CD диск с записью музыки




Магнитола

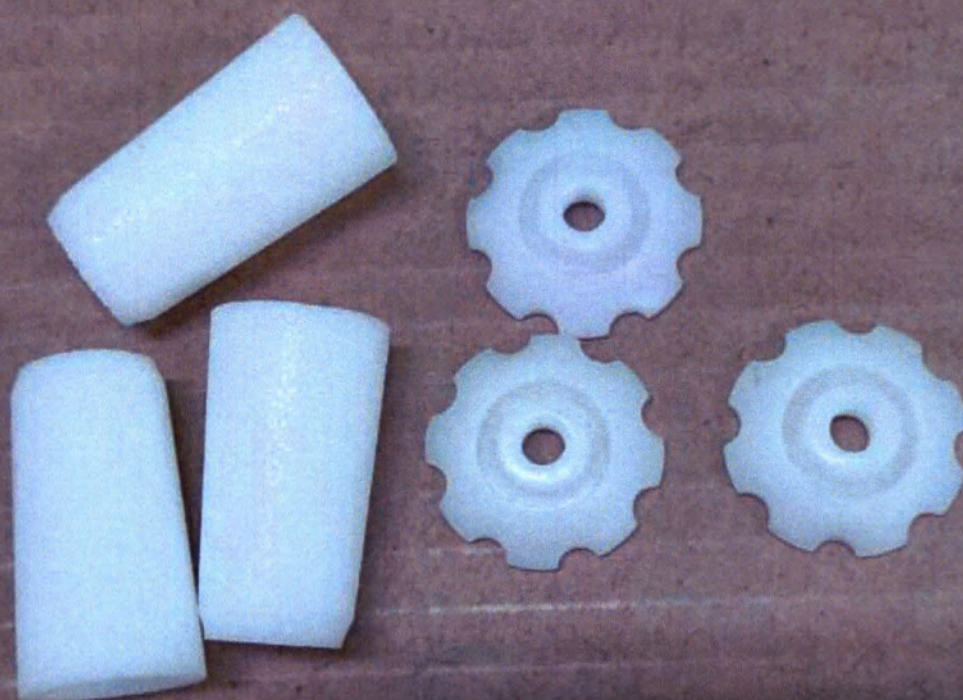

Комплект ЗИП



Пульт медсестры

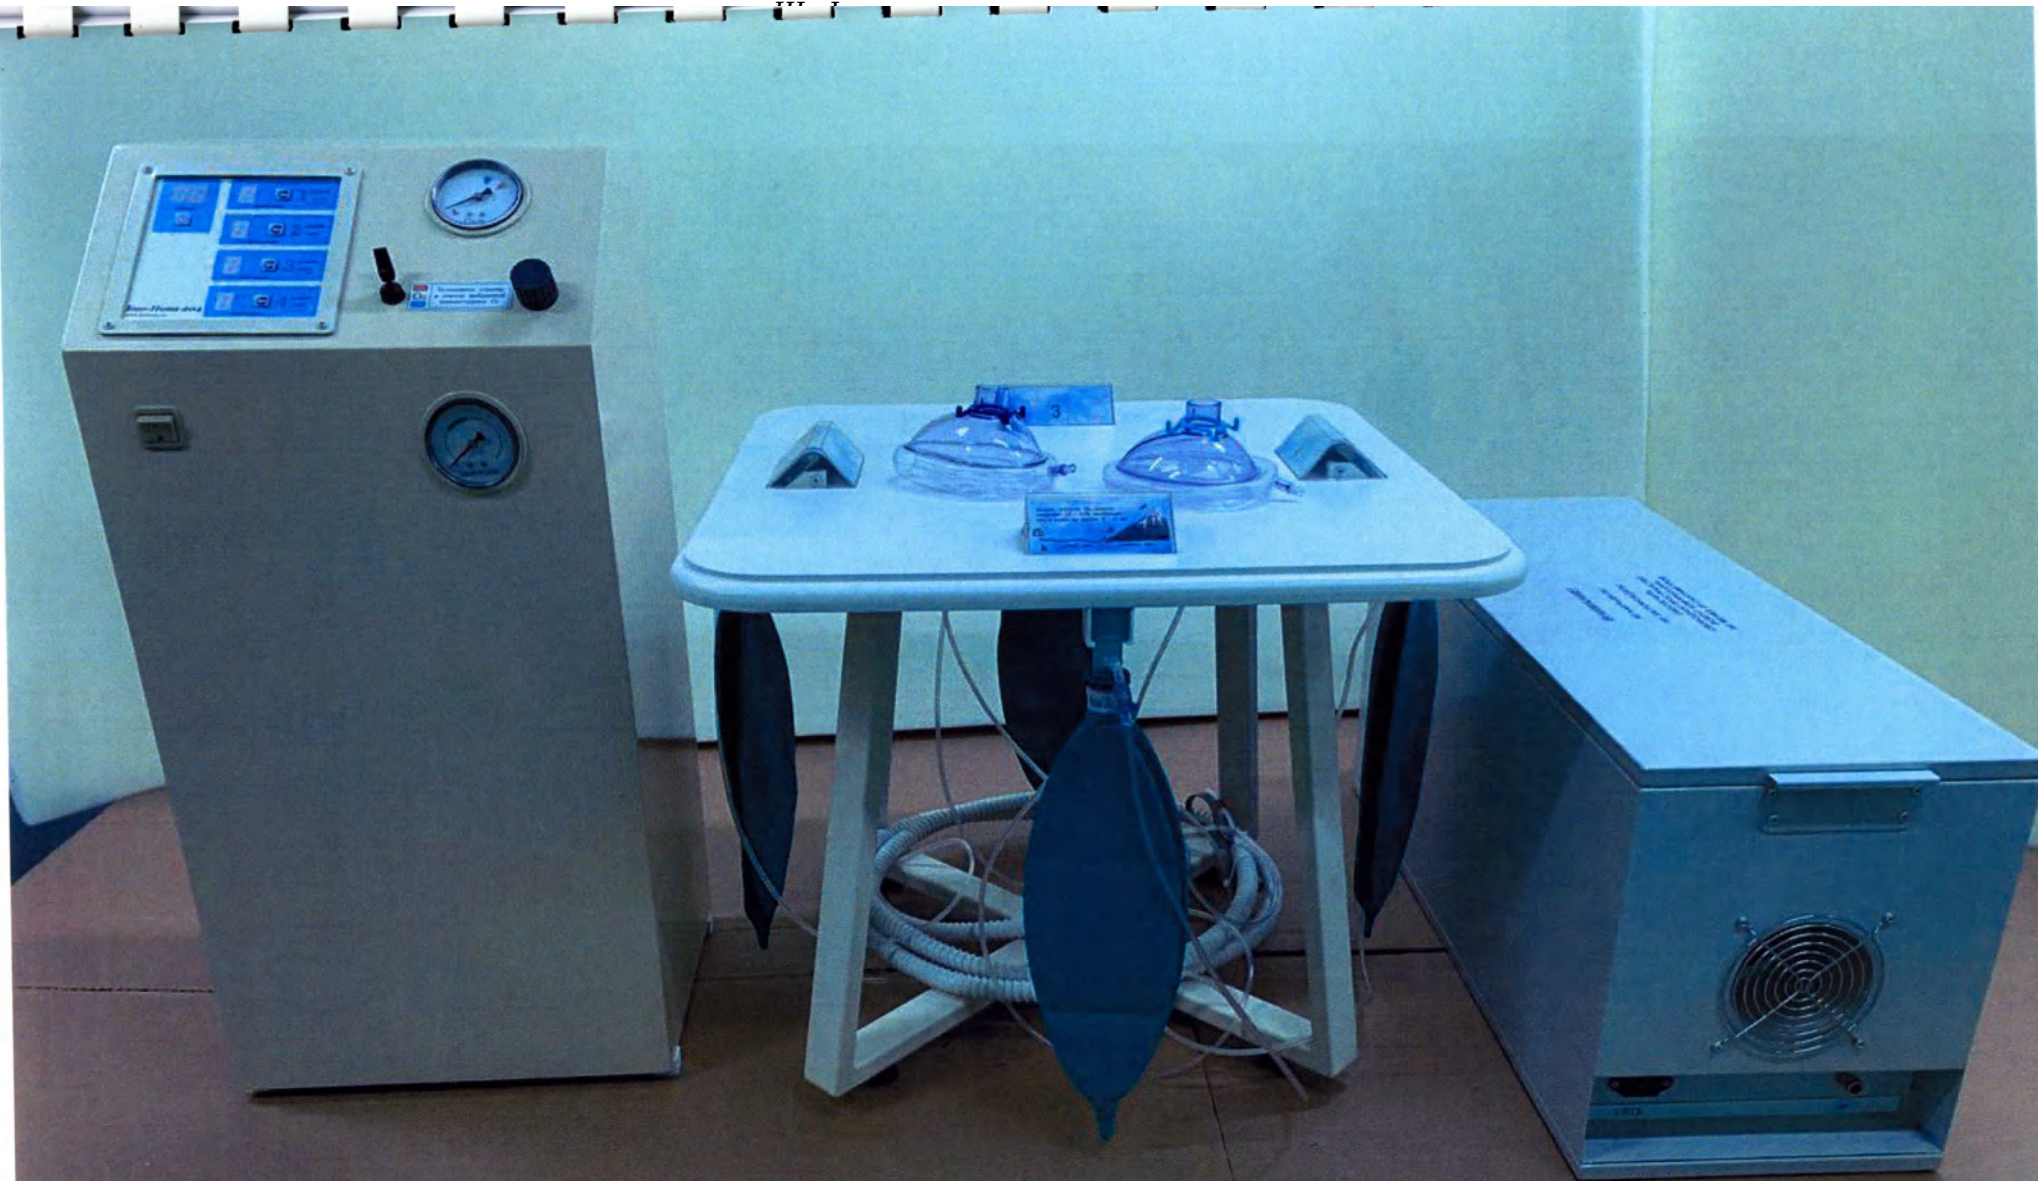

Установка для гипокситерации четырехместная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания «БИО-НОВА-204» по ТУ 9444-001-40059061-98



Установка для гипоксигенации четырехместная с индивидуальным заданием и индикацией программ дыхания «БИО-НОВА-204» по ТУ 9444-001-40059061-98