



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.

«16» декабря 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Наконечник эндодонтический EQ-M в комплекте».

Производства: Meta Systems Co. LTD.

адрес: 1211-1218, Sicox tower 12F, 484, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 13229, Korea

Рисунок 1. Общий вид упаковки МИ «Наконечник эндодонтический EQ-M в комплекте»



Рисунок 2. Общий вид упаковки МИ «Наконечник эндодонтический EQ-M в комплекте»

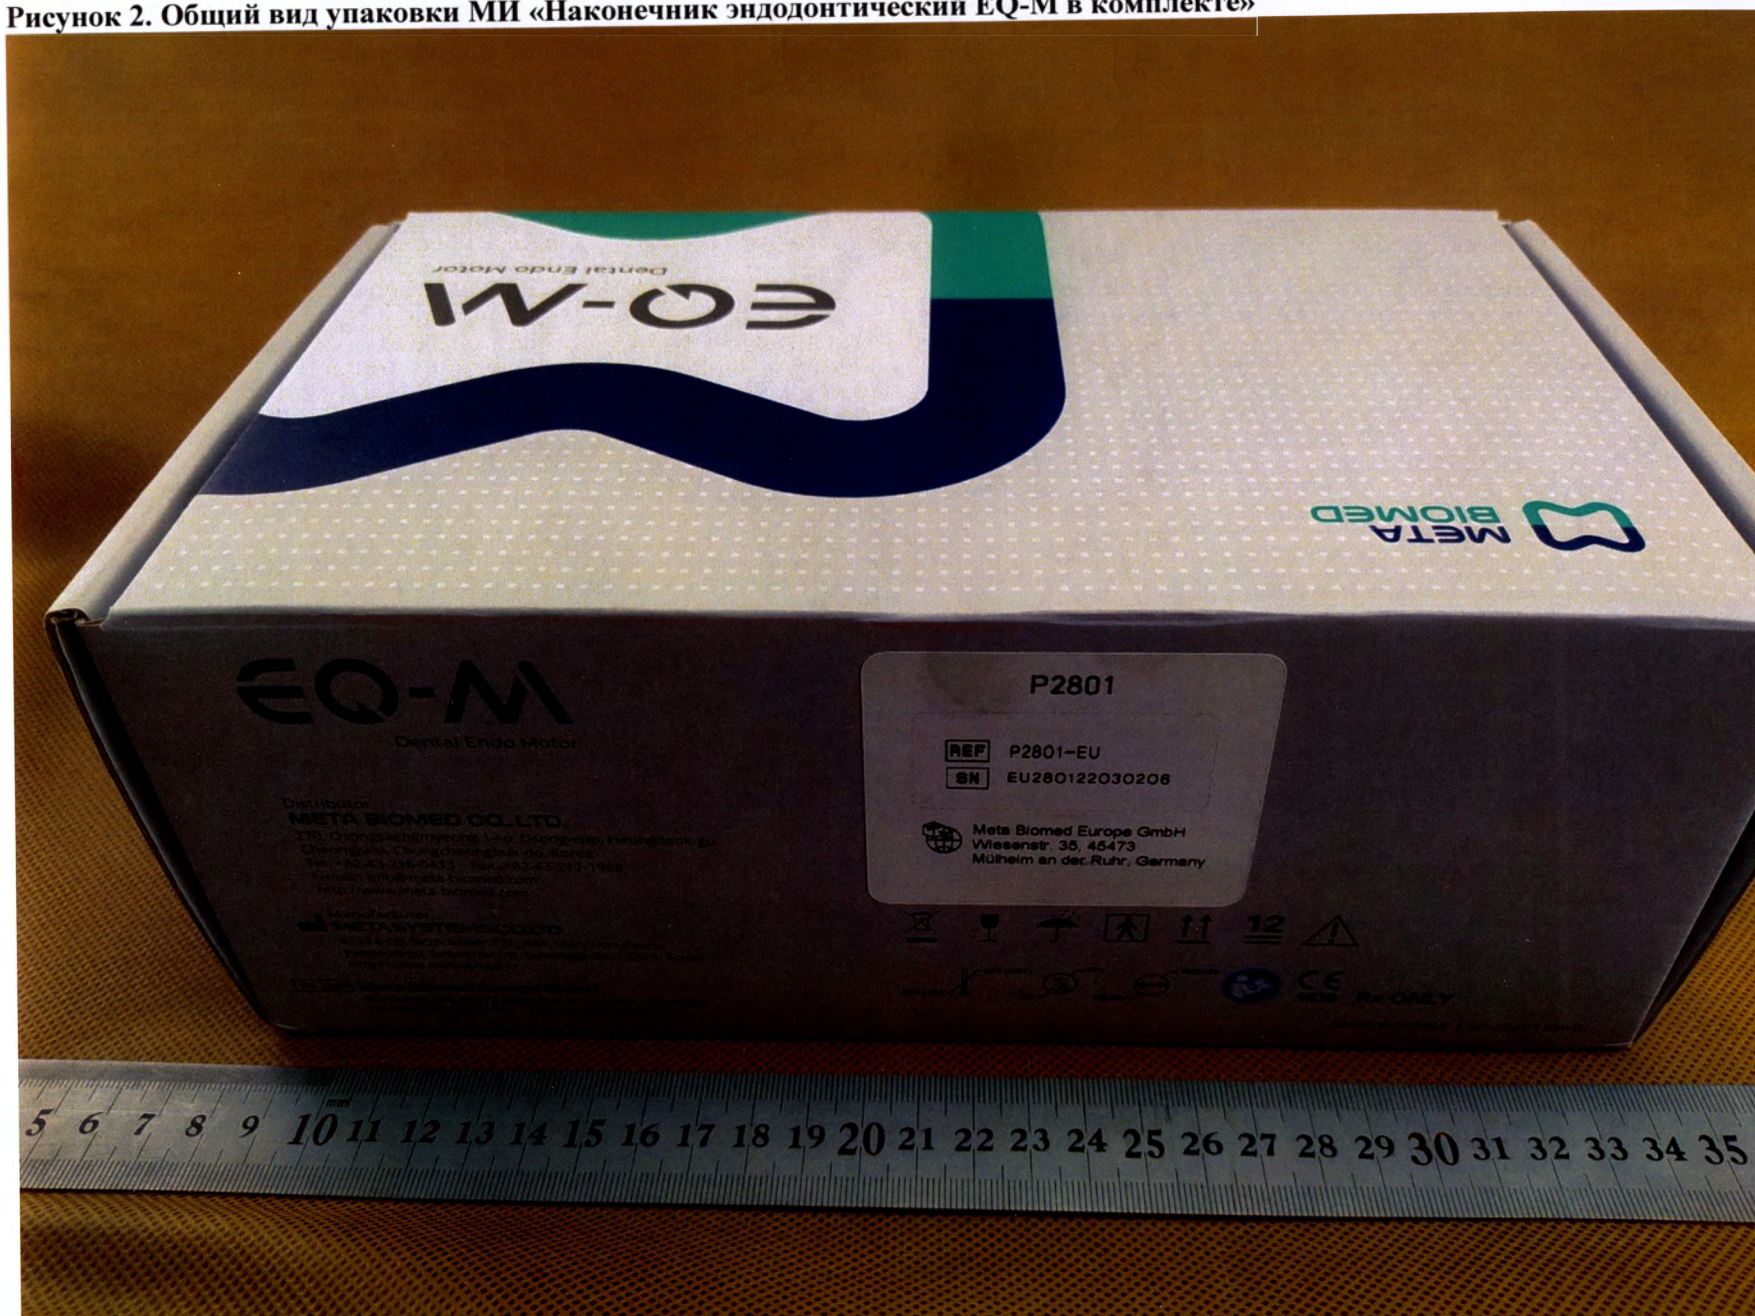


Рисунок 3. Общий вид состава упаковки МИ «Наконечник эндодонтический EQ-M в комплекте»



Рисунок 4. Вид при открытии упаковки МИ «Наконечник эндодонтический EQ-M в комплекте»



Рисунок 5. Моторный наконечник



Рисунок 6. Угловая головка



Рисунок 7. Зарядное устройство – подставка (фронтальный вид)

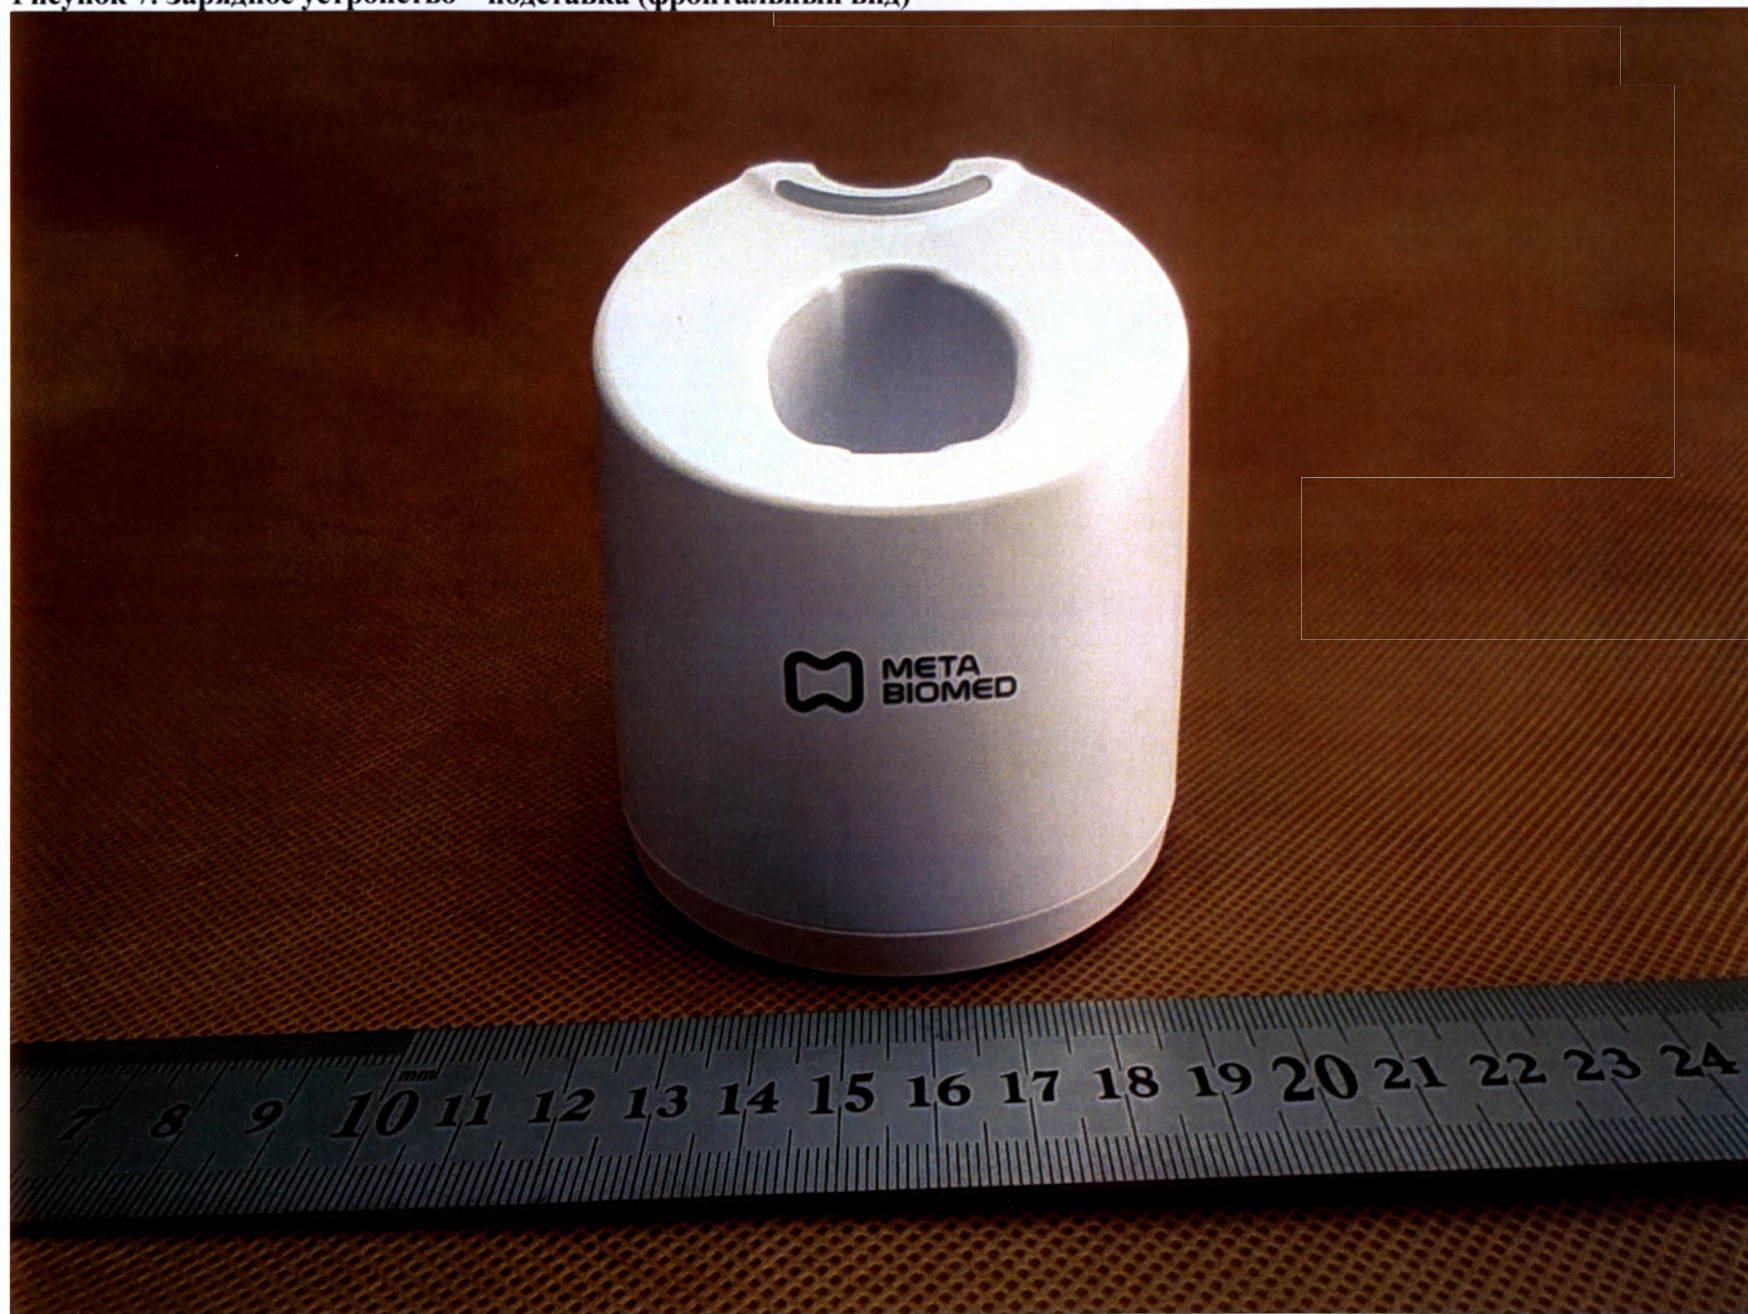


Рисунок 8. Аккумулятор Li-Ion (DC 3,7В)



8.1. Перевод на русский язык надписи, указанной на маркировке Аккумулятора Li-Ion (DC 3,7В)


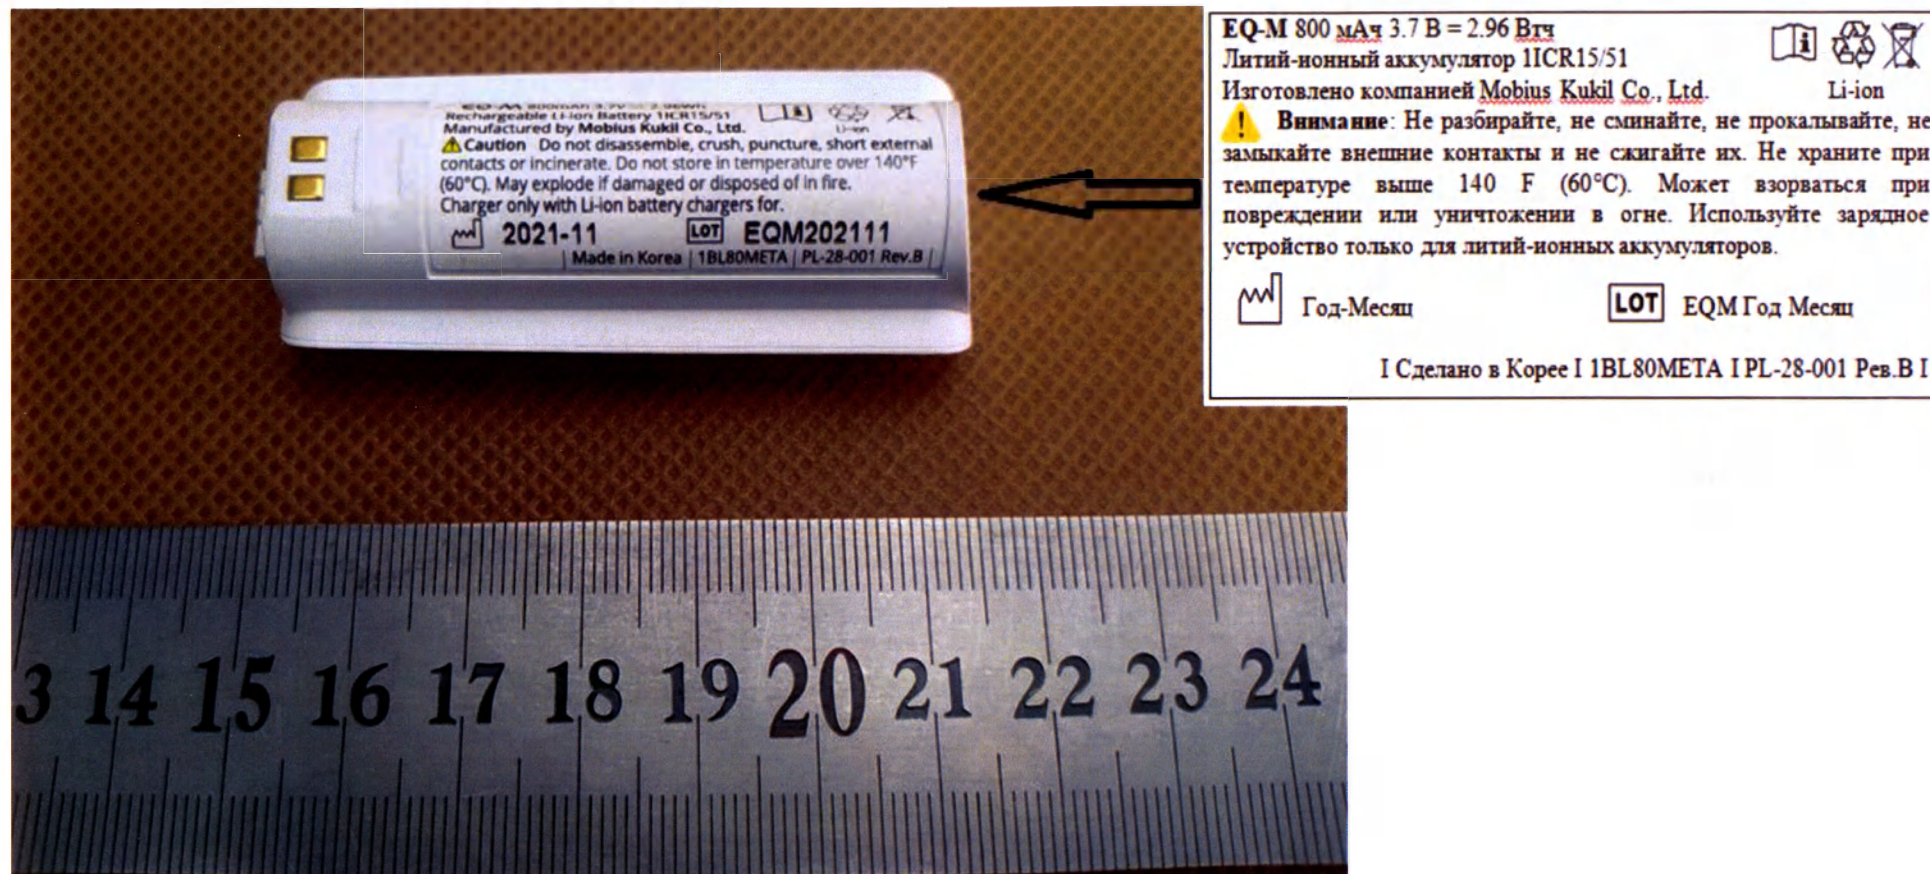


Рисунок 9. Сетевой адаптер (100-240В/50-60Гц)



9.1. Перевод на русский язык надписи, указанной на маркировке Сетевого адаптера (100-240В/50-60Гц)

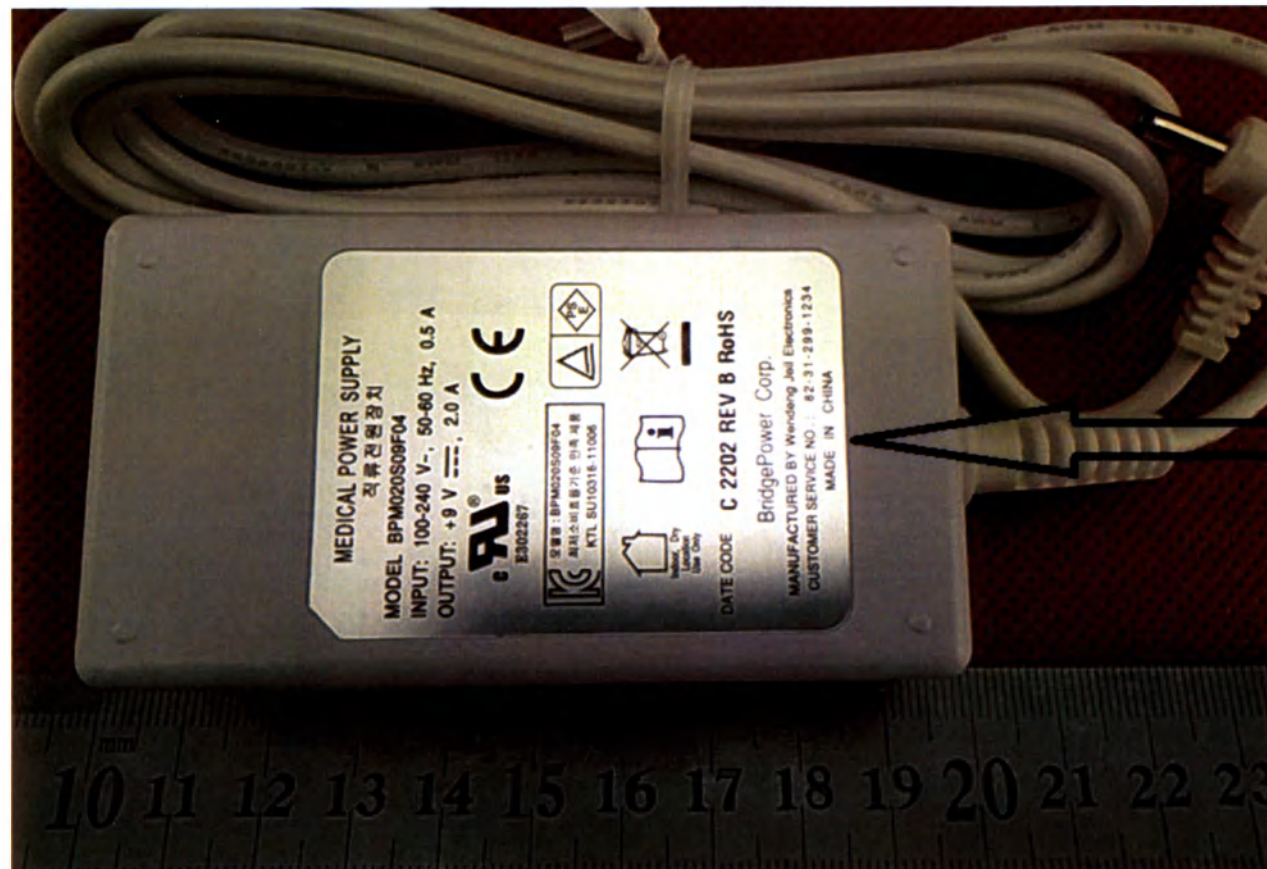

Медицинский источник питания

Устройство источника постоянного тока

Модель BPM020S09F04


Вход: 100-240 В~, 50-60 Гц, 0.5 А

Выход: +9 В ---, 2.0 А



Название модели: PM020S09F04

Продукты соответствующие минимальным
стандартам эффективности потребления
KTL SU 10316-11006



Используйте только
в помещении,
в сухом месте

Код даты

C 2125 КУМ II RoHS

Bridge Power Corp.

Изготовлено компанией Wendeng Jell Electronics

Обслуживание клиентов №: 82-31-299-1234

Сделано в Китае

Рисунок 10. Сетевой кабель


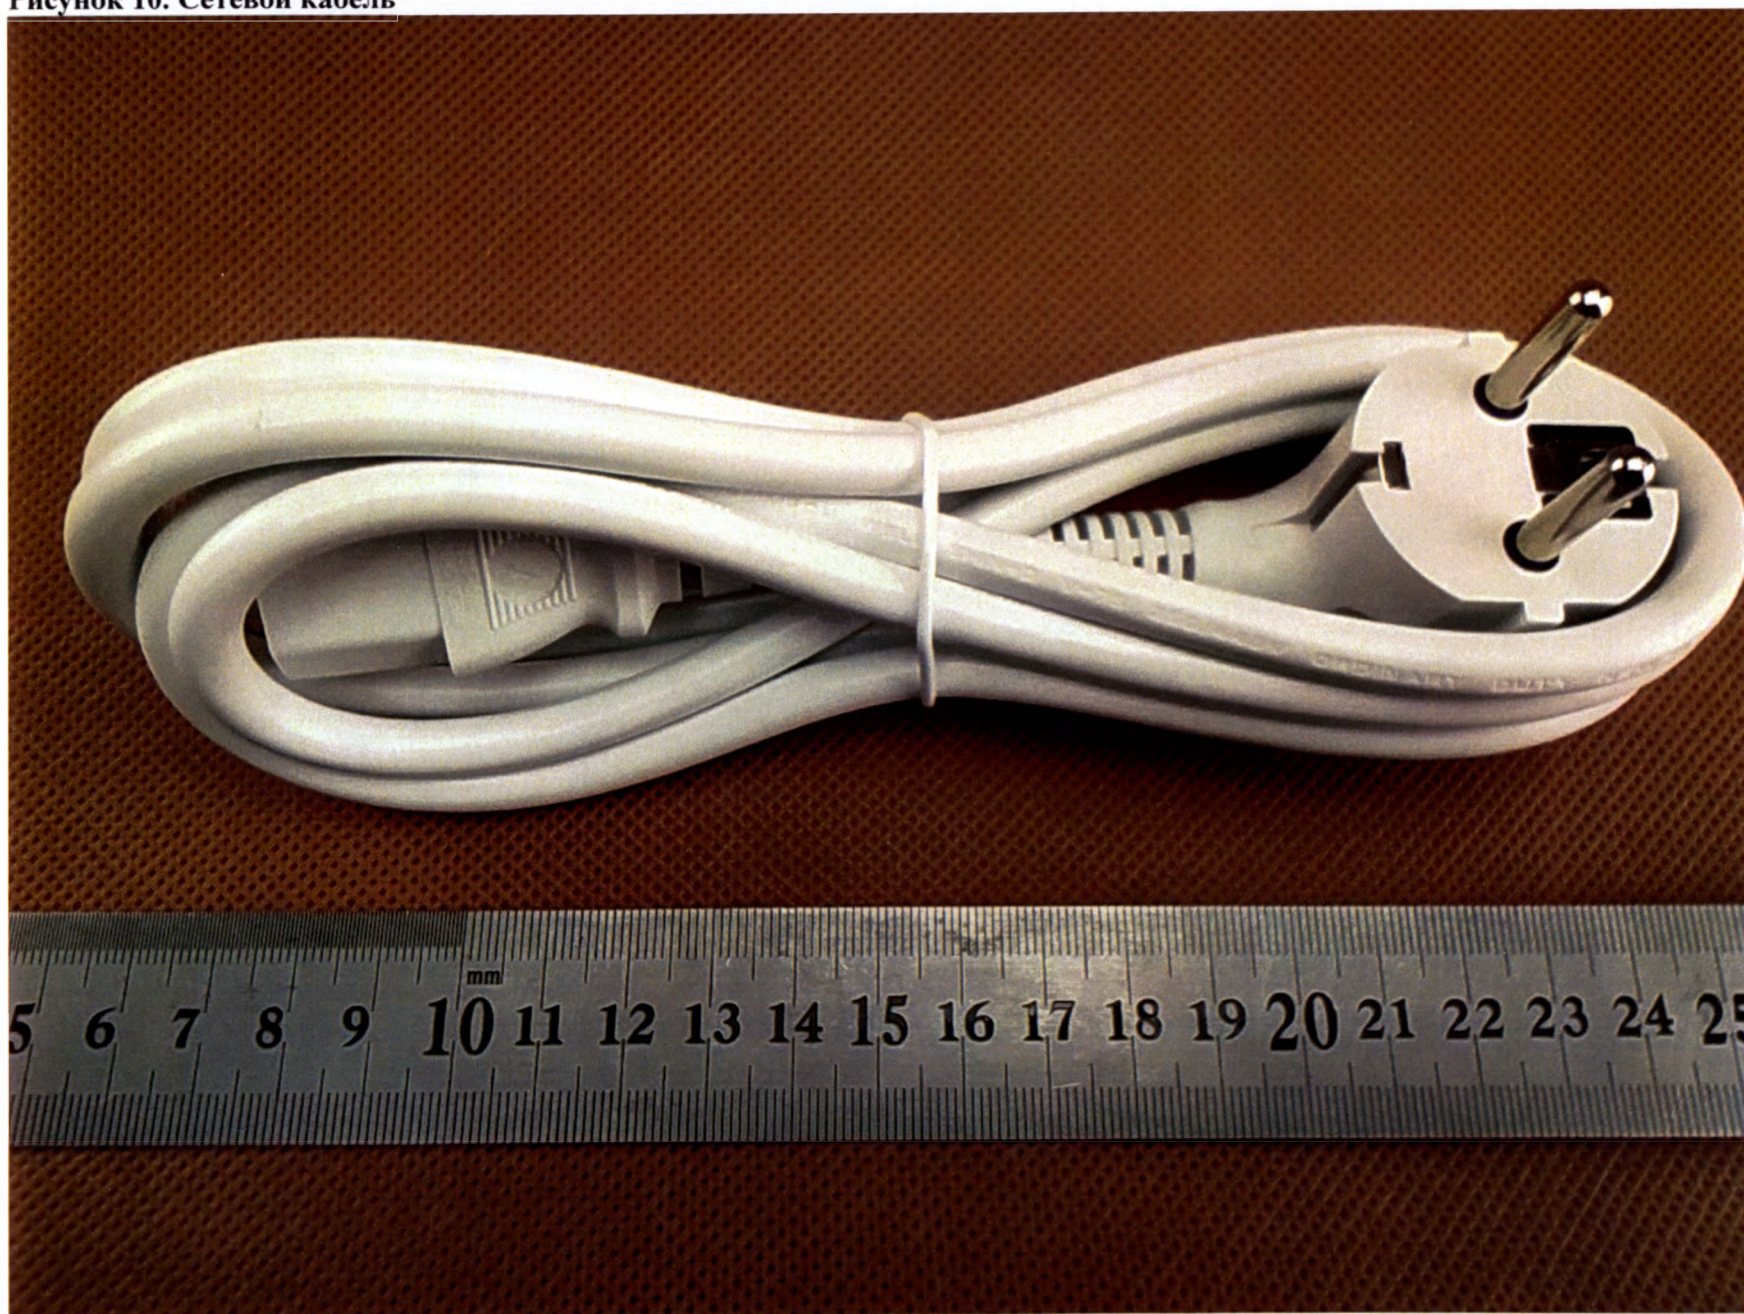


Рисунок 11. Защитные чехлы одноразовые для наконечника, уп/100 шт.

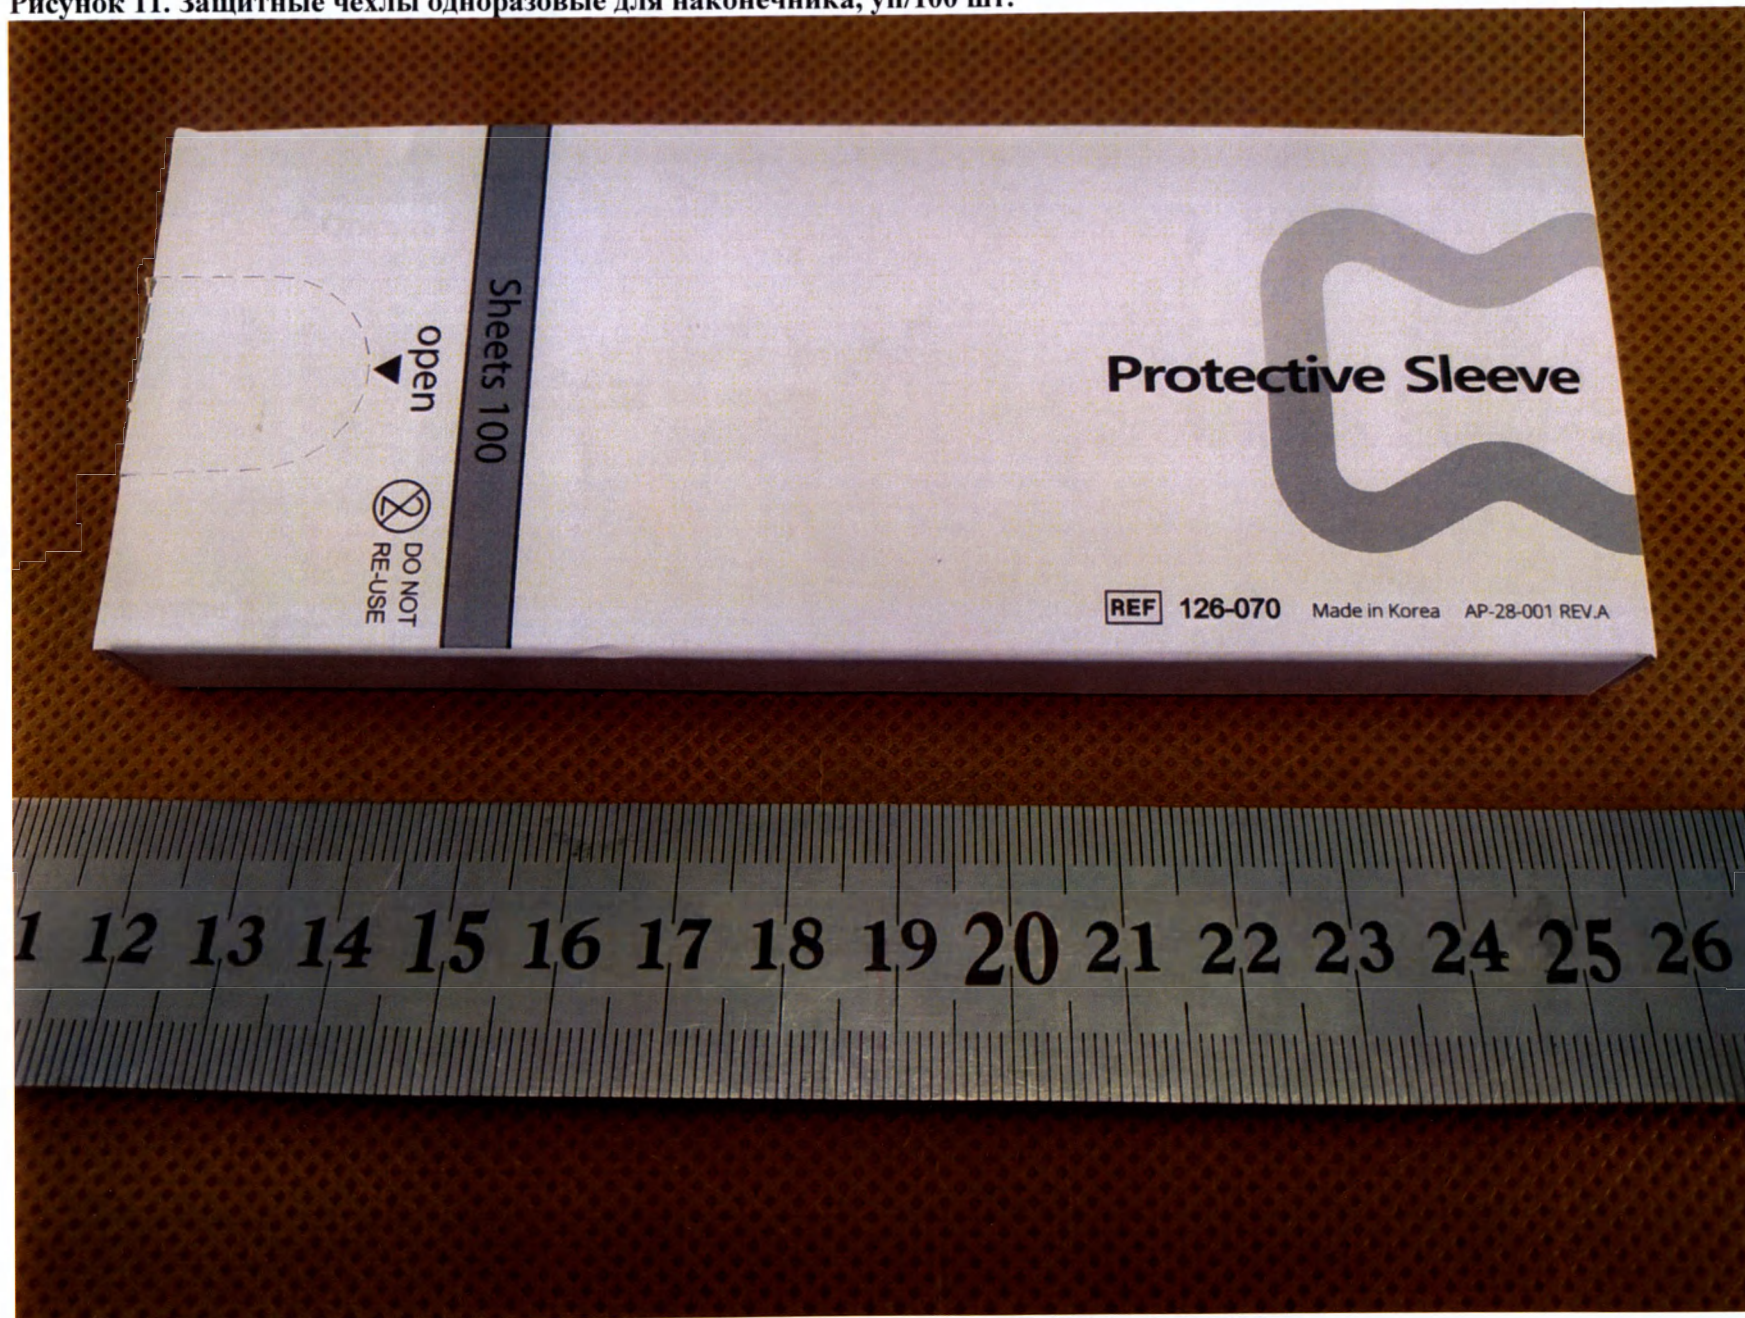

Перевод на русский язык надписи, указанной на маркировке Сетевого адаптера (100-240В/50-60Гц)

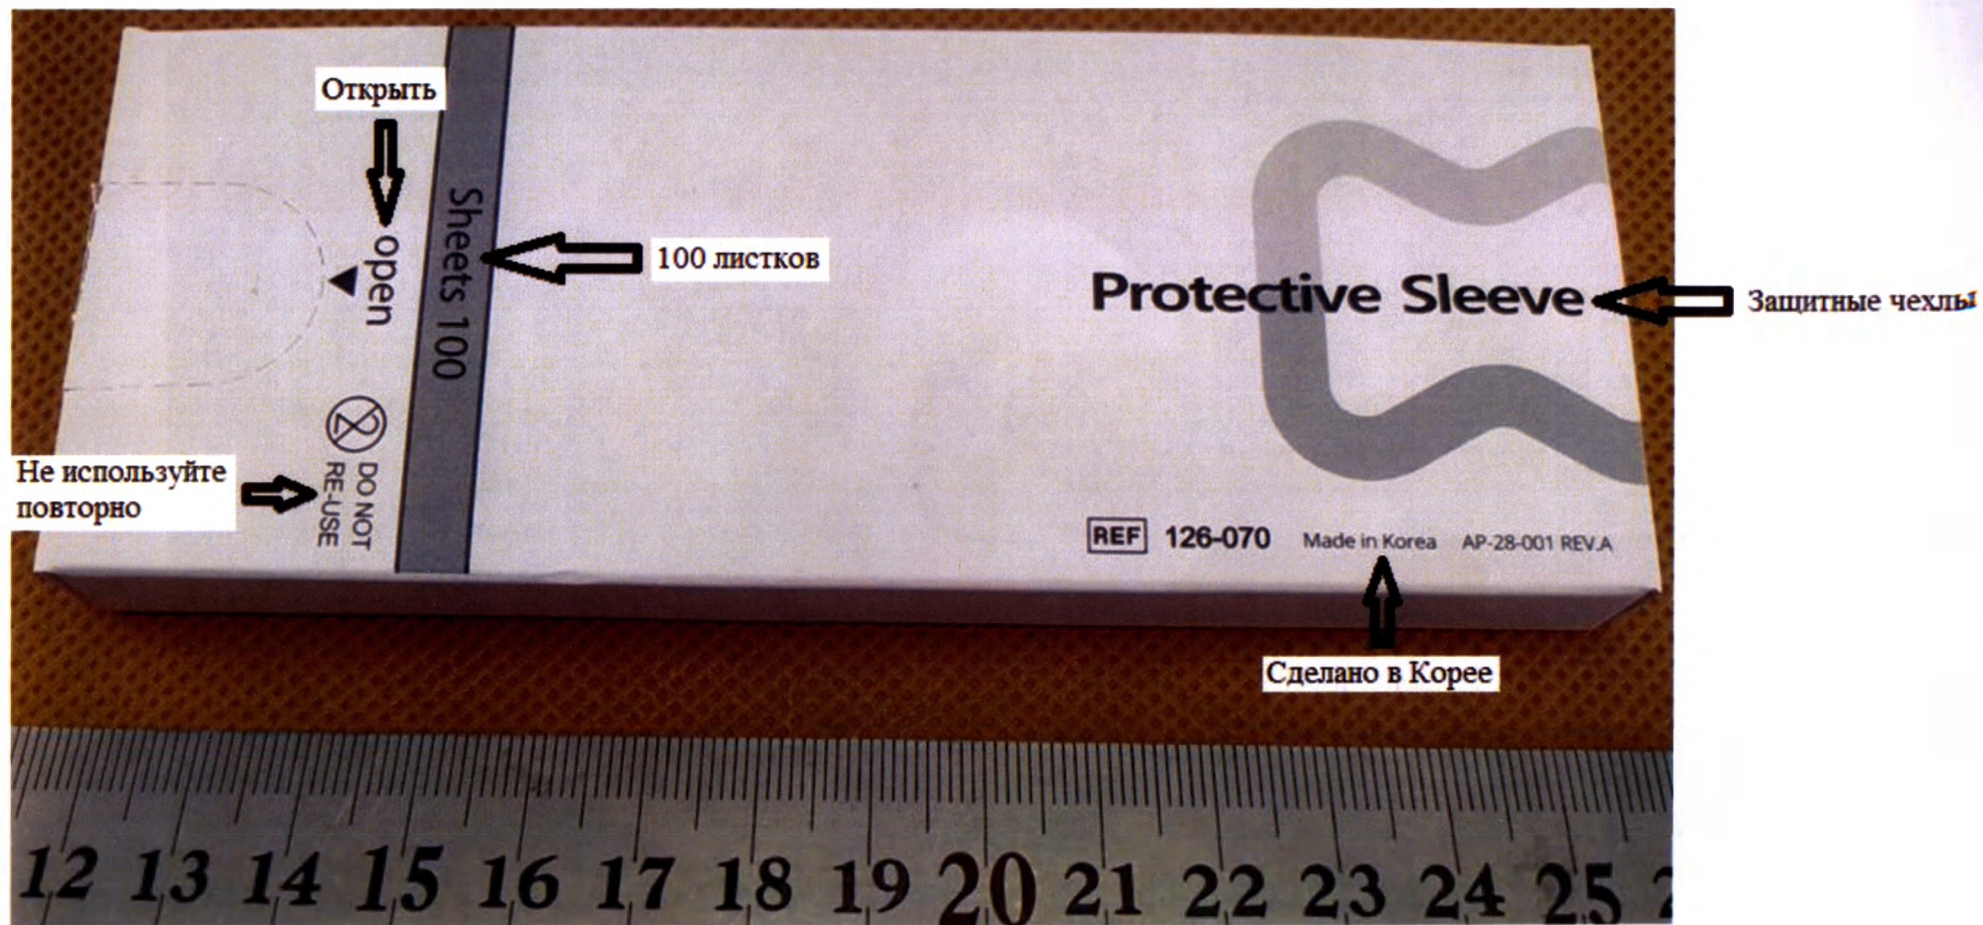


Рисунок 12. Моторный наконечник в зарядном устройстве - подставке


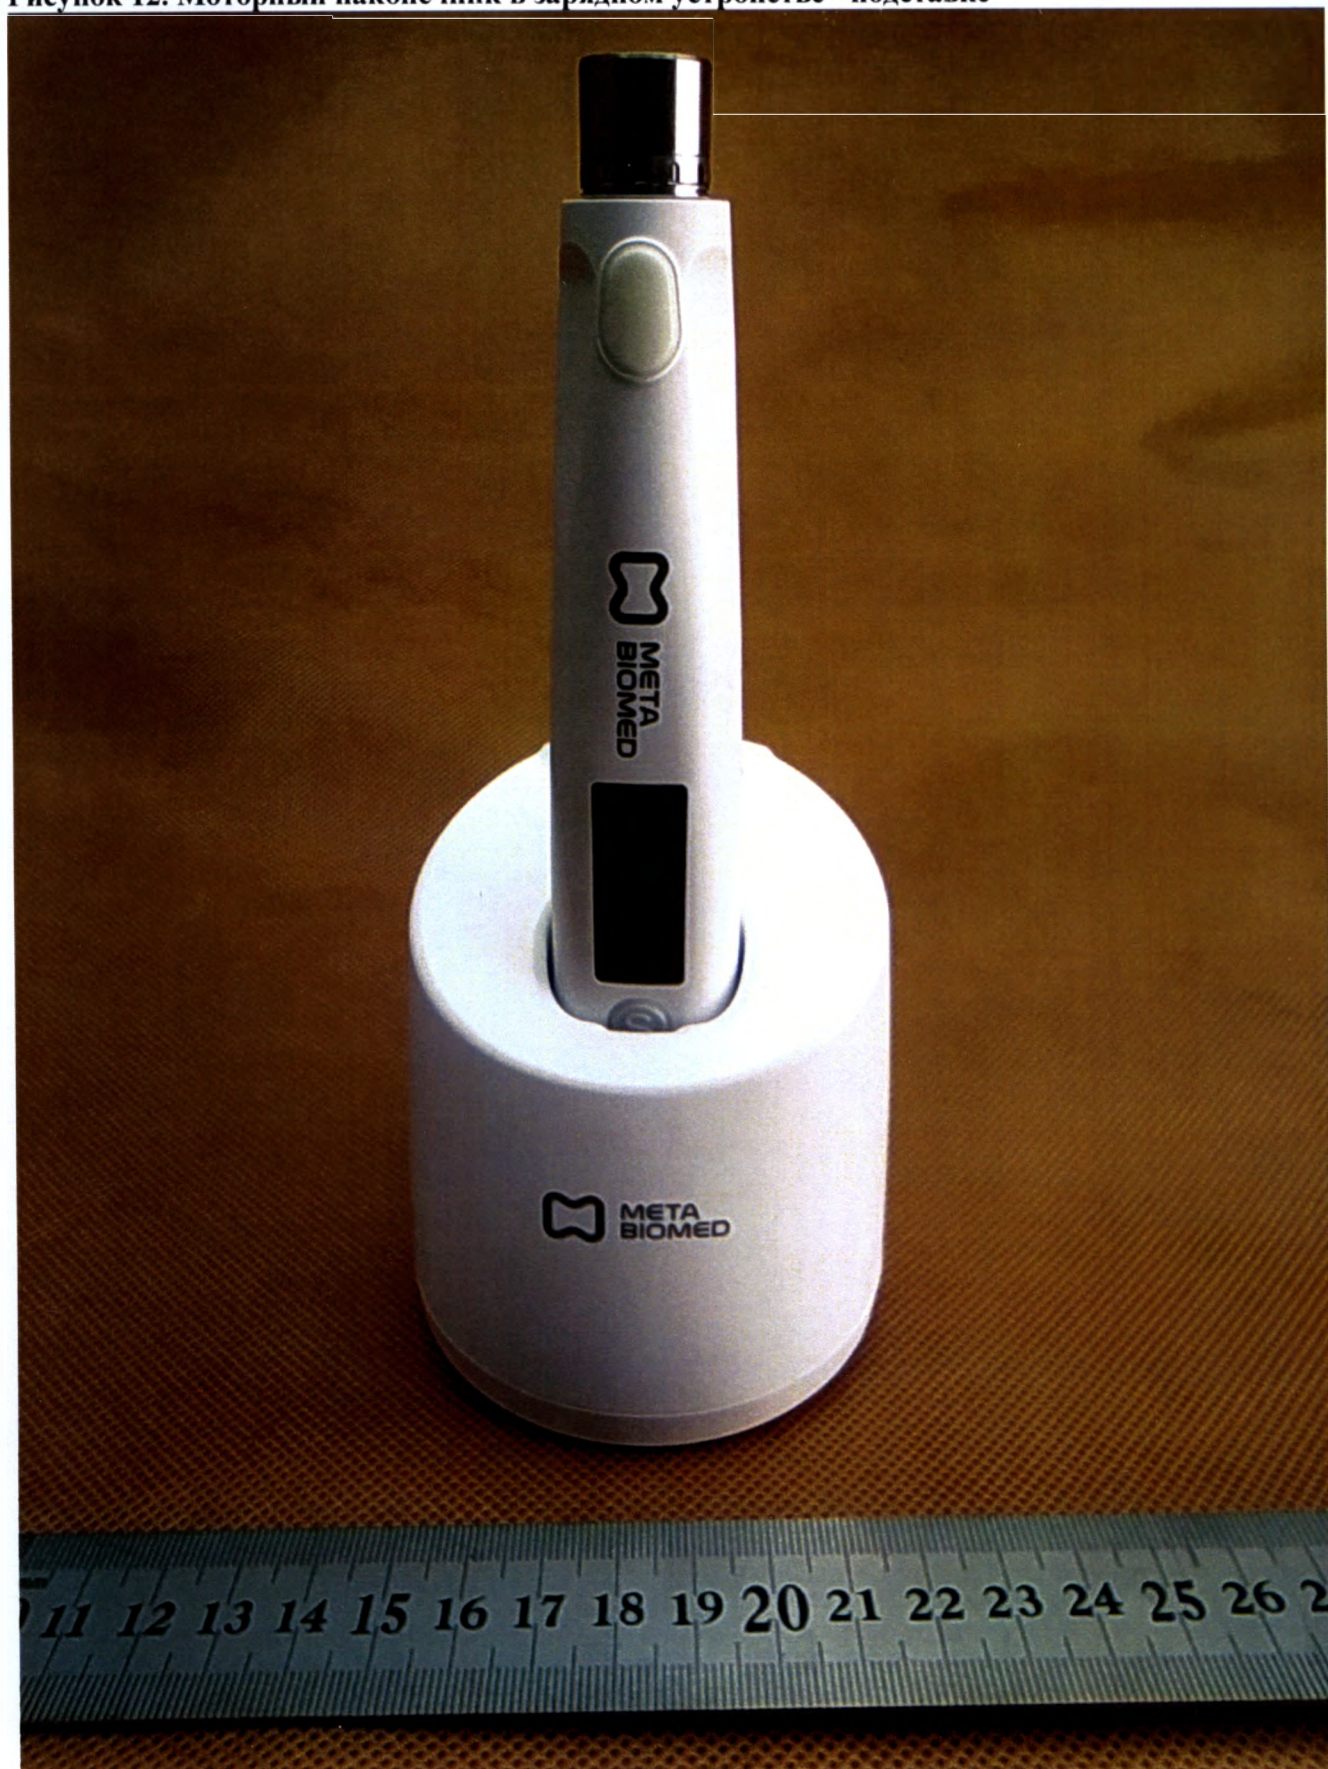


Рисунок 13. Зарядное устройство - подставка (вид снизу)



13.1. Перевод на русский язык надписи, указанной на зарядном устройстве - подставке

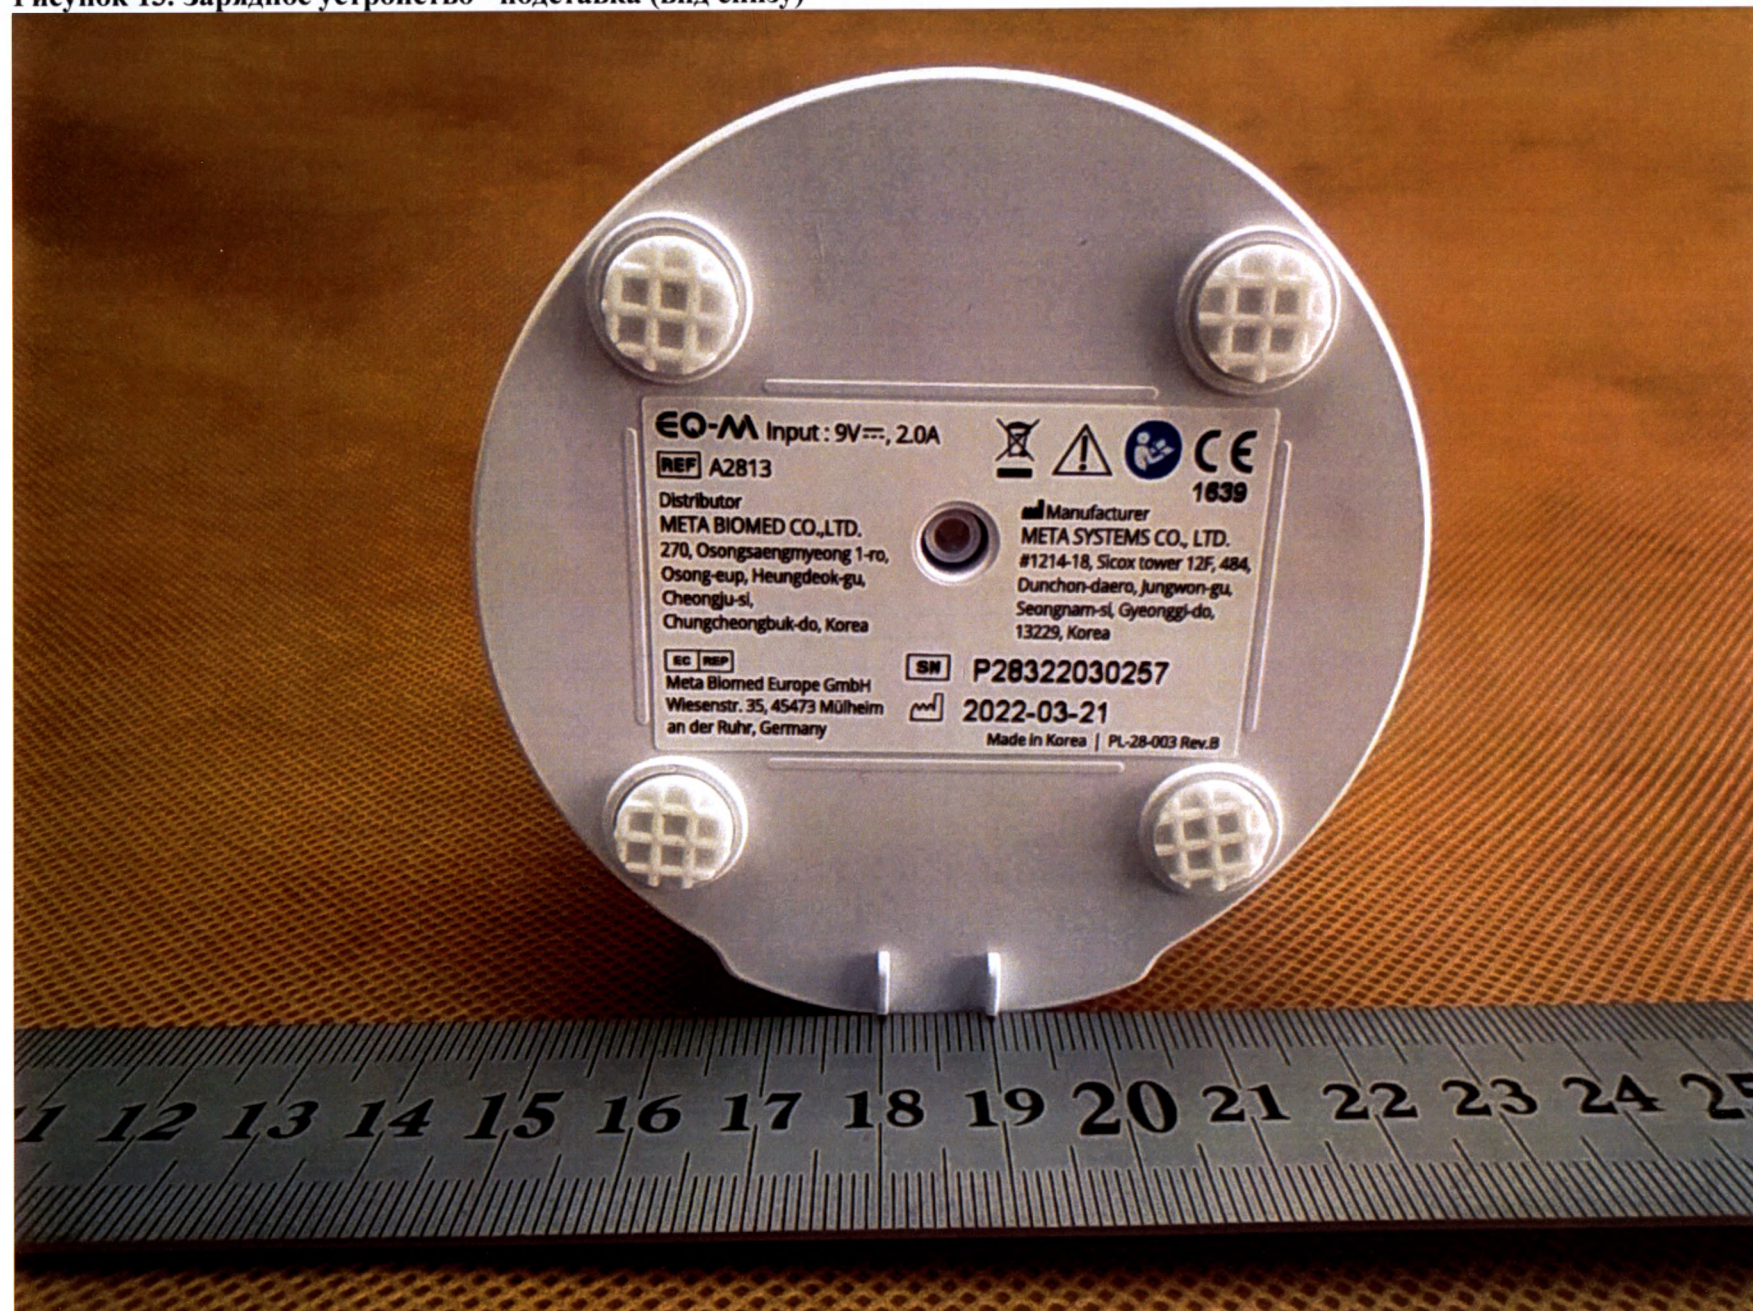

EQ-M Вход: 9 В --- , 2.0 A

REF A2813

Дистрибьютор
META BIOMED CO., LTD.
270, Osongsaengmyeong 1-ro,
Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Korea

EC **REP**

Meta Biomed Europe GmbH
Wiesenstr. 35, 45473 Mulheim
an der Ruhr, Germany



Изготовитель
META SYSTEMS CO., LTD
#1214-18, Sicox tower 12F, 484,
Dunchon-daero, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do,
13229, Korea

SN P28222030257



2022-03-21
Сделано в Корее I PL-28-003 Rev.B

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

18 (восемнадцать) листов

Ген. Директор ООО «Медента»



В. В. Терехов