



ДМС ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

8-499-501-34-35, 8-495-746-80-22 e-mail: info@dms-at.ru www.dms-at.ru



приоритет
Система менеджмента качества
сертифицирована по стандарту
ИСО 9001:2008

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-,
трехсуточного мониторингa ЭКГ, АД, ЧП КМкн-«Союз-«ДМС»,
упаковки и маркировки.**




















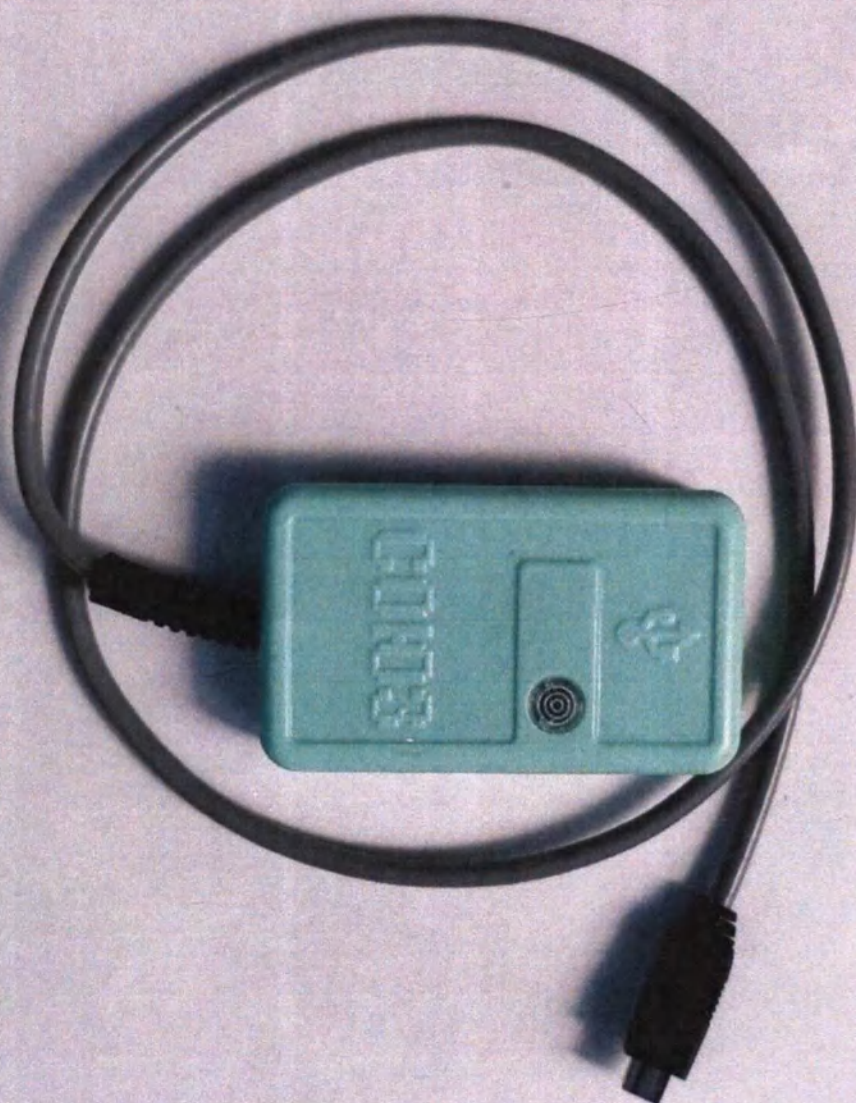





наименование медицинского изделия:
инструменты медицинские хирургические
стерильные, в наборах и отдельных упаковках

Канюля назальная кислородная

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕ ТОКСИЧНО, СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА

SIZE/РАЗМЕР

XS ☐ S ☐ L ☒

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ВНИМАНИЕ

- Хранить при температуре от -5°C до +30°C.
- Не использовать после истечения срока годности.
- При нарушении целостности упаковки не использовать.
- После использования утилизировать.

Производитель:

«Чанчжоу Хуанганг Медицинское Устройство Ко. Лтд.», Китай
Changzhou Huanggang Medical Device Co., Ltd., Jiaosi Industrial District,
Changzhou, Jiangsu 213116, China

Импортер в Россию:

ООО «Шингва», г. Новосибирск, ул. Демкина, 30, оф. 901, 630090
Р/У № ФСЗ 2011/11322 от 30.12.2011 г.



CONTEC™



PULSE OXIMETER

CMS 50 FW

Small in volume, light in weight and convenient to carry

SpO₂ value display

Pulse rate value display, bar graph and pulse waveform display

Screen brightness can be changed

With clock and alarm function

Battery capacity indication

SpO₂ and pulse rate value can be recorded, the storage data can be uploaded to computers

Connected with an external oximeter probe

Wireless communication function






21



13. Ассиметричный коаксиальный кабель для электрокардиографии с разъемом ПК 10-10P-12P

10. пятипроводный коаксиальный кабель пациента для холтеровского монитора с разъемом НК 10-10Р-12Р и защитой от разряда
кардиодефибриллятора

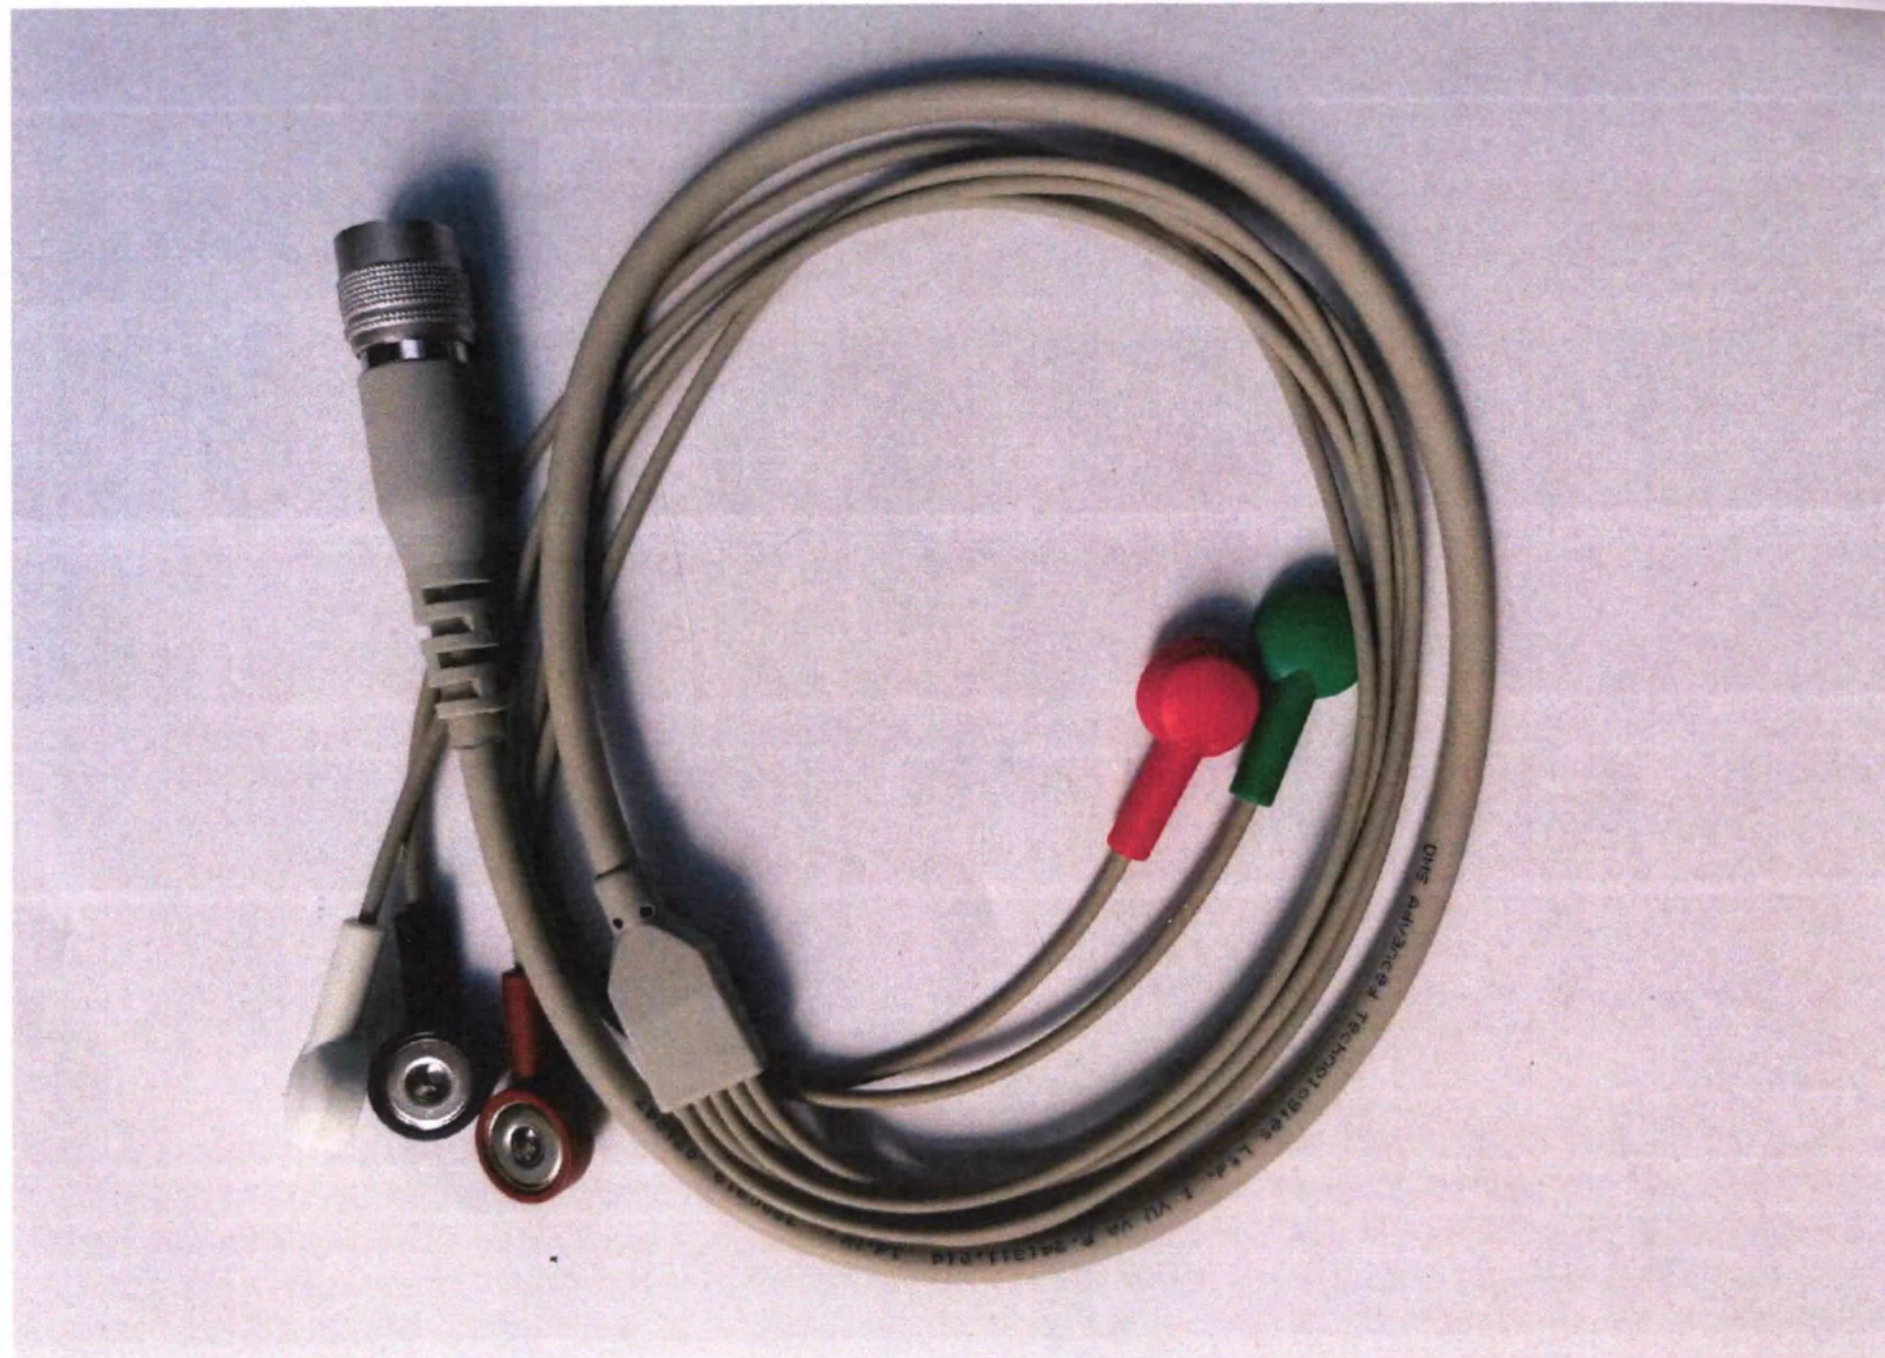







RIGHT



www.dms-at.ru

DMS ADVANCED TECHNOLOGIES

BLOOD PRESSURE CUFF

LARGE ADULT

22 - 42 cm



www.dms-at.ru

DMS ADVANCED TECHNOLOGIES

BLOOD PRESSURE CUFF

MEDIUM ADULT

23 - 32 cm



- ☐ 115 x 270 мм, для манжет малых размеров
☒ 150 x 330 мм, для манжет средних размеров
☐ 175 x 430 мм, для манжет больших размеров

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ МАНЖЕТ

Предназначены для индивидуального использования при суточном и многосуточном мониторинге артериального давления.

- исключают непосредственное соприкосновение манжеты многократного использования с телом пациента и делают мониторинг более комфортным
- обладают высокой впитывающей способностью при потоотделении пациента
- не мешают проведению исследования и не влияют на точность измерения артериального давления
- существенно продлевают срок службы манжеты и сохраняют её внешний вид.

ИЗДЕЛИЕ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Состав: целлюлоза, хлопок, полиэстер.

Срок годности не ограничен, хранить в сухом месте.





50 штук

ООО "ДМС Передовые Технологии"
тел.: 8-495-746-80-22 8-499-501-34-35
www.dms-at.ru e-mail: info@dms-at.ru

98

27. Датчик ионов водорода (минипровод)

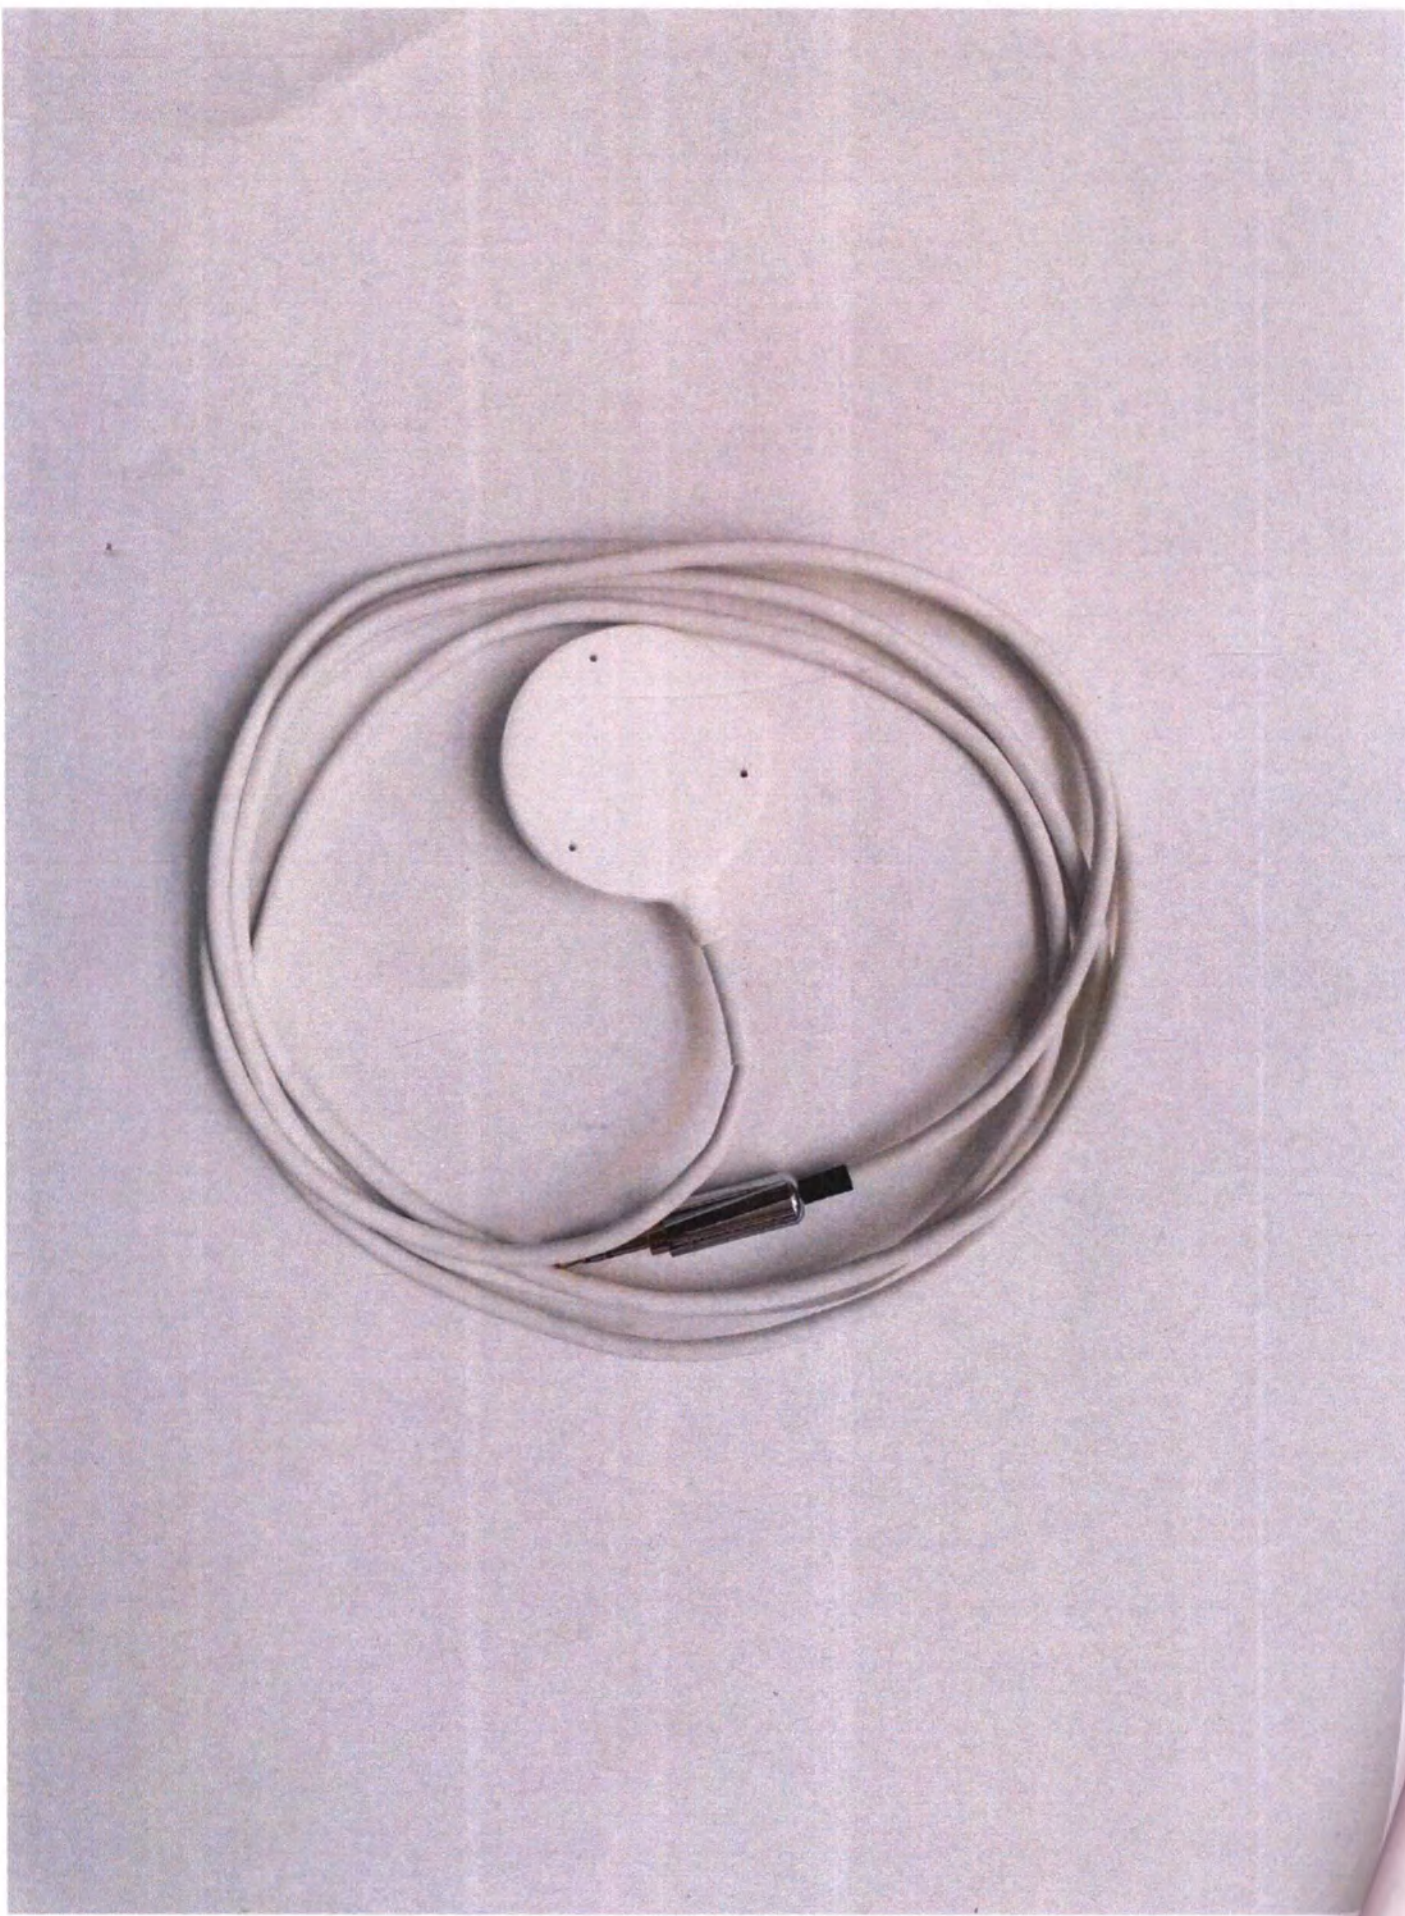

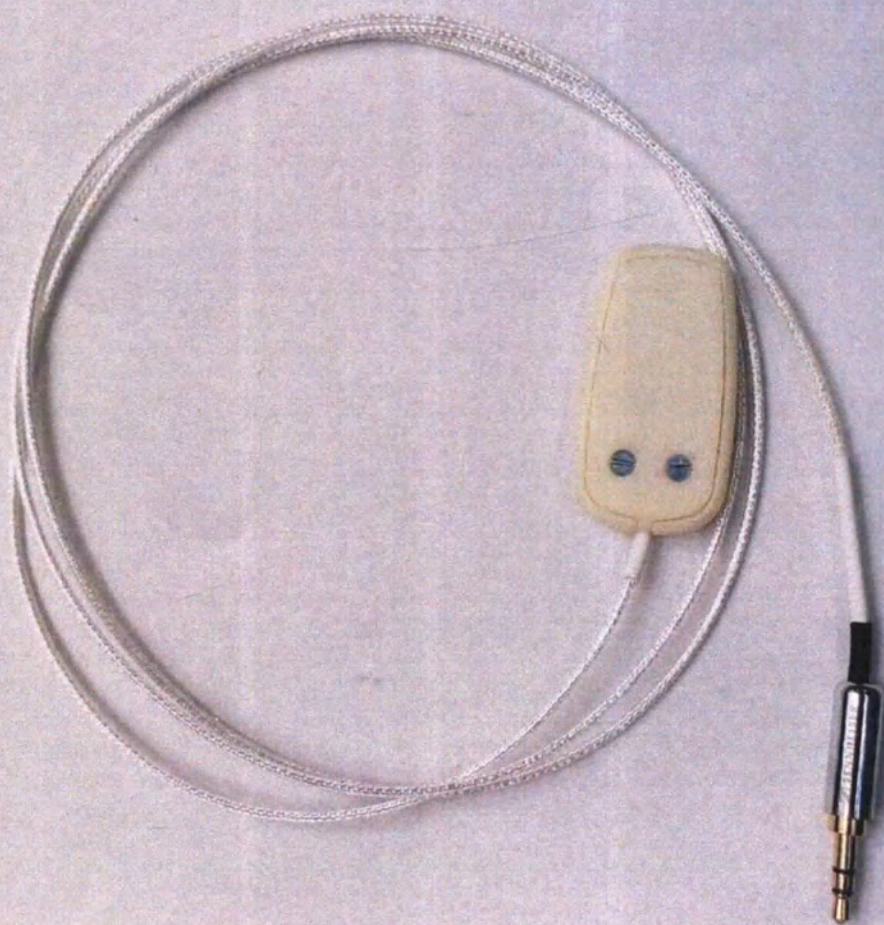



The power supply specialist
ROBITON® MasterCharger 2B Plus


Автоматическое зарядное устройство

- Подходит для 1-2 Ni-MH, Ni-Cd, LiFePo₄, высокотоковых и стандартных Li-ion аккумуляторов
- Поддерживает размеры AAAA, AAA, AA, A, SC, C, 10440, 16340 (RCR123), 14500, 17500, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700, 26650, 26700
- Микропроцессорный контроль и наблюдение за процессом заряда
- Функция восстановления глубоко разряженных аккумуляторов
- Защита от переполновки, короткого замыкания и перезаряда




Ni-MH
Ni-Cd
LiFePo₄
Li-ion



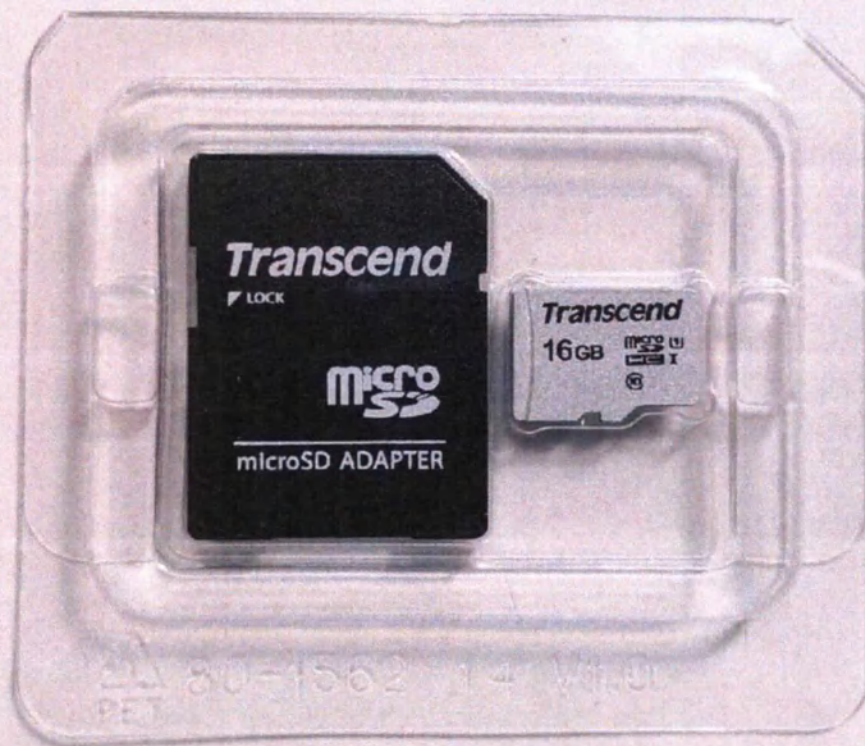





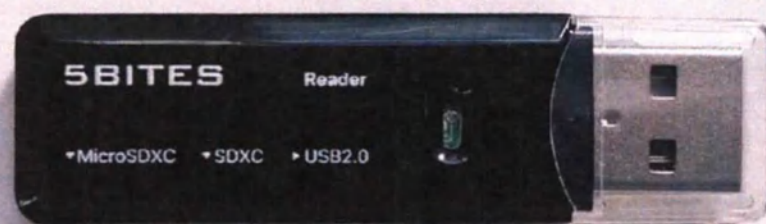





Комплект мониторов компьютеризированных носимых
одно, двух, трёхсуточного мониторингирования ЭКГ, АД, ЧП
КМкн-«СОЮЗ»-«ДМС»
ИЮЯР.941319.001



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЮЯР.941311.021РЭ

Программное обеспечение
«СОЮЗ-ДИАГНОСТИКА»

Программа для оценки состояния и выявления
нарушений в работе функциональной системы
организма человека



EAC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПЛЕКТ МОНИТОРОВ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ
НОСИМЫХ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ, АД, ЧП

КМкн-«СОЮЗ»-«ДМС»

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С МОНИТОРОМ
МЭКГ-ДП-НС-01 2/3/12 канальный

EN ECG ELECTRODES
DE EKG-ELEKTRODEN
FR ELECTRODES ECG
IT ELETTRODI PER ECG

SKINTACT®



www.skintact.com

PREMIER

02485 / 23:40:18

30 x REF FS-50



UDI



GTIN 19005531580289

LOT 230620-0093


2025-06-20

(01)19005531580289(10)230620-0093(17)250820



5-8028

Made in Austria

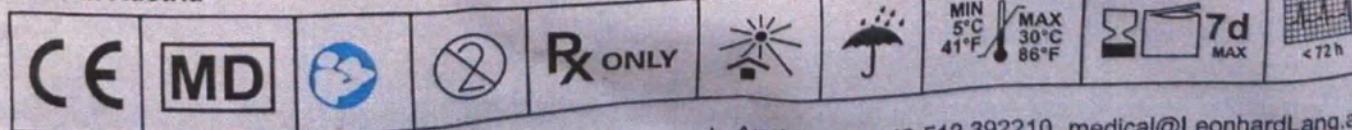

Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, 6020 Innsbruck, Austria; fax +43 512 392210, medical@LeonhardLang.at

36. Принтер лазерный



37. Персональный компьютер





Windows 10



Планшетный компьютер
bb-mobile Techno W8.0 3G



Упаковка

ООО «ДМС Передовые Технологии»
129301, Москва, ул. Б. Галушкина, д. 17-VII.
Сервисный центр: +7(499) 501-34-35



Наименование продукции:


**Комплект мониторов компьютеризированных
носимых одно-, двух-, трехсуточного
мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-"Союз-"ДМС"**
ТУ 9441-001-46816787-2004
РУ №РЗН 2014/1478 от 07.12.2022

МЭКГ-ДП-НС-01м № _____

Дата упаковывания _____ г.

КОМПЛЕКТ №	МЕСТО №	ВСЕГО МЕСТ В КОМПЛЕКТЕ
1	1	1



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
42 ЛИСТОВ
Генеральный директор

Ларьонов С.А.