

PHILIPS

Руководитель отдела
нормативного регулирования

ООО «ФИЛИПС»

Град А.А.


2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями»

Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S и Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X, в составе.

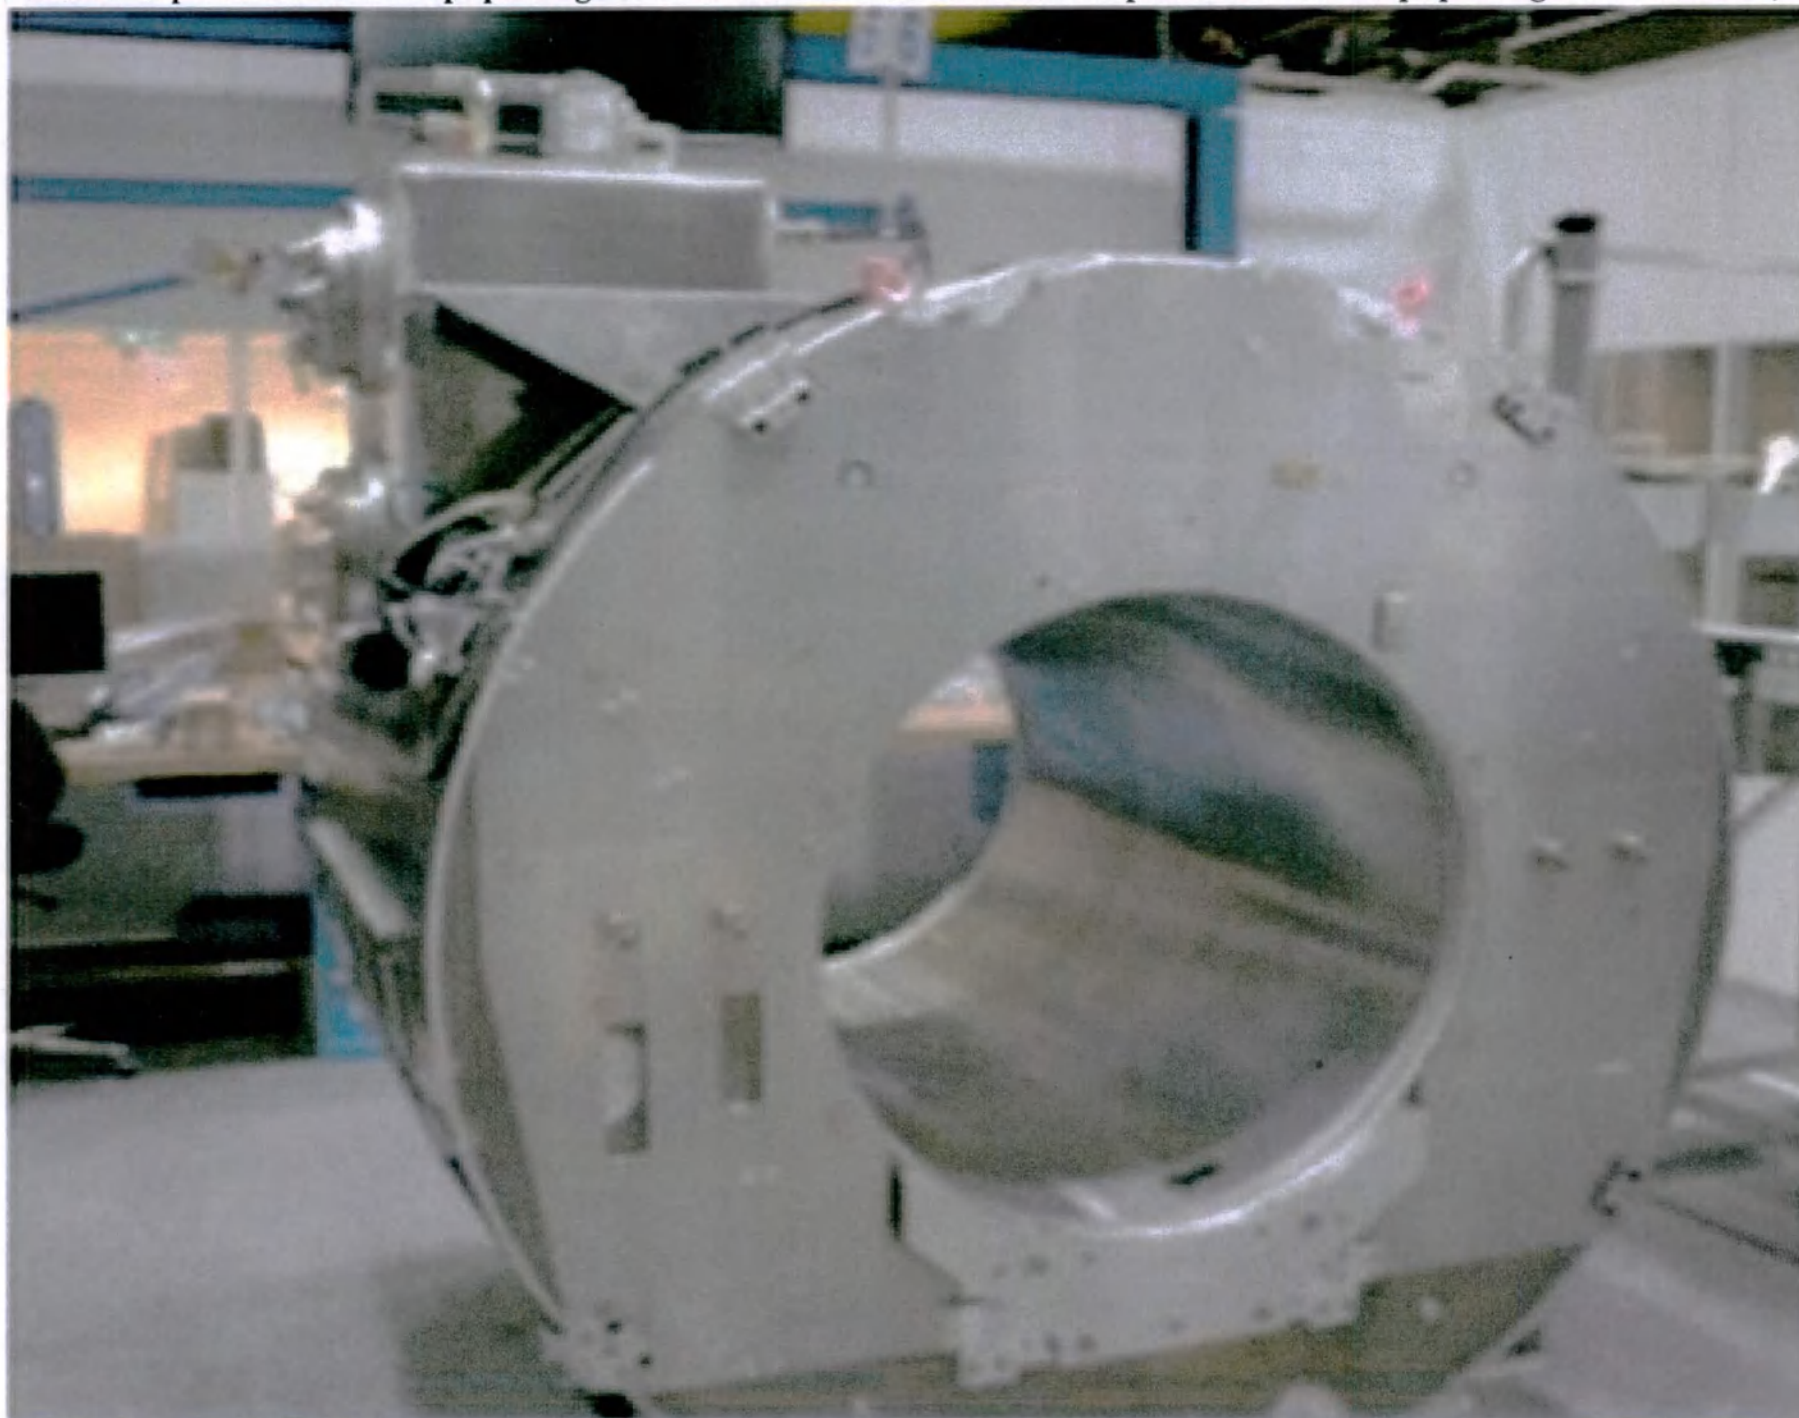


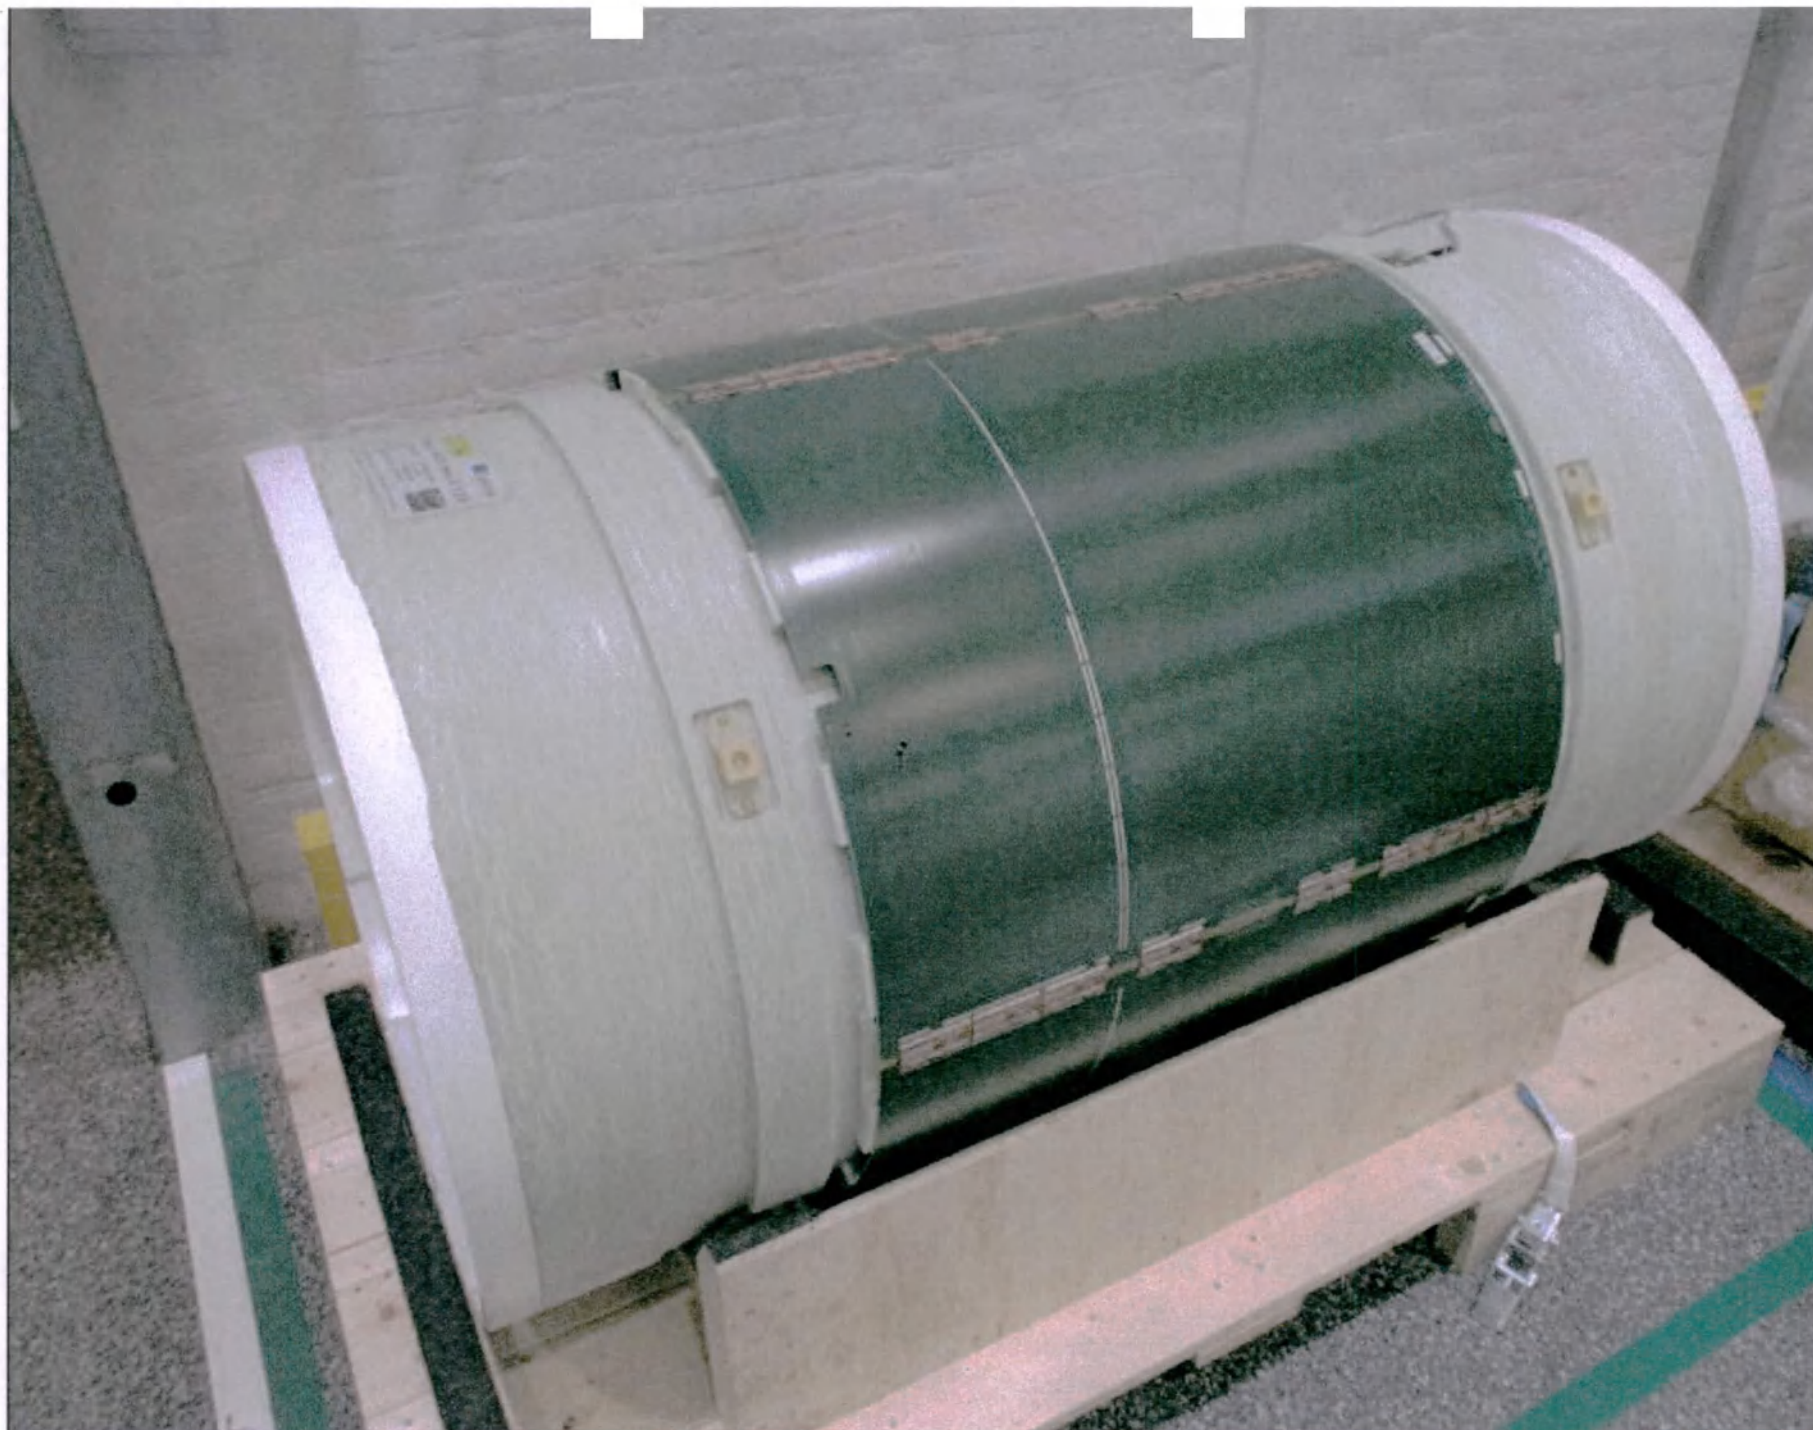

2. Градиентная система. Градиентная катушка.

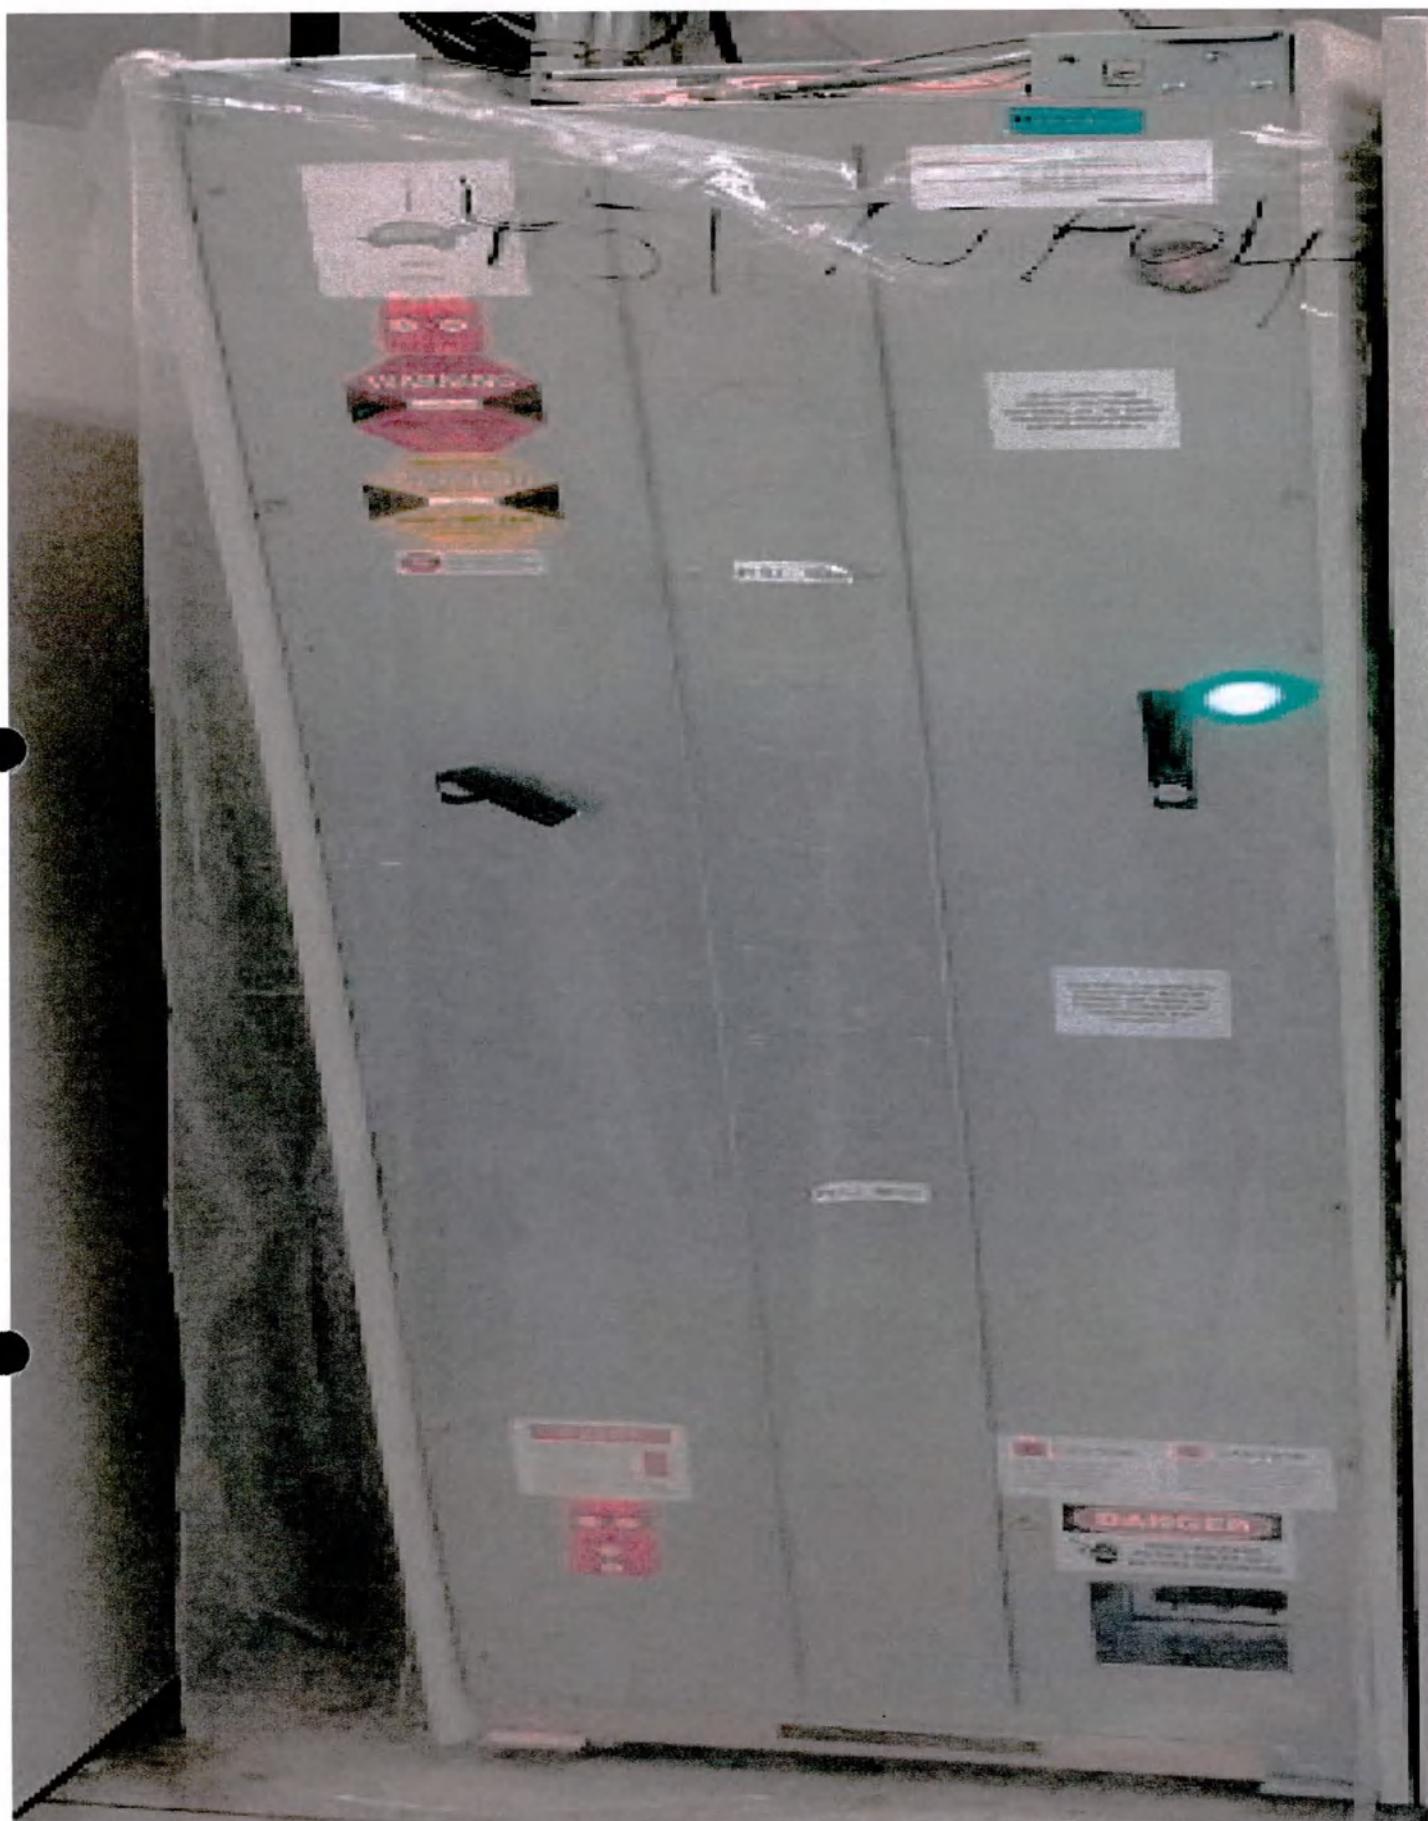


2. Градиентная система Omega

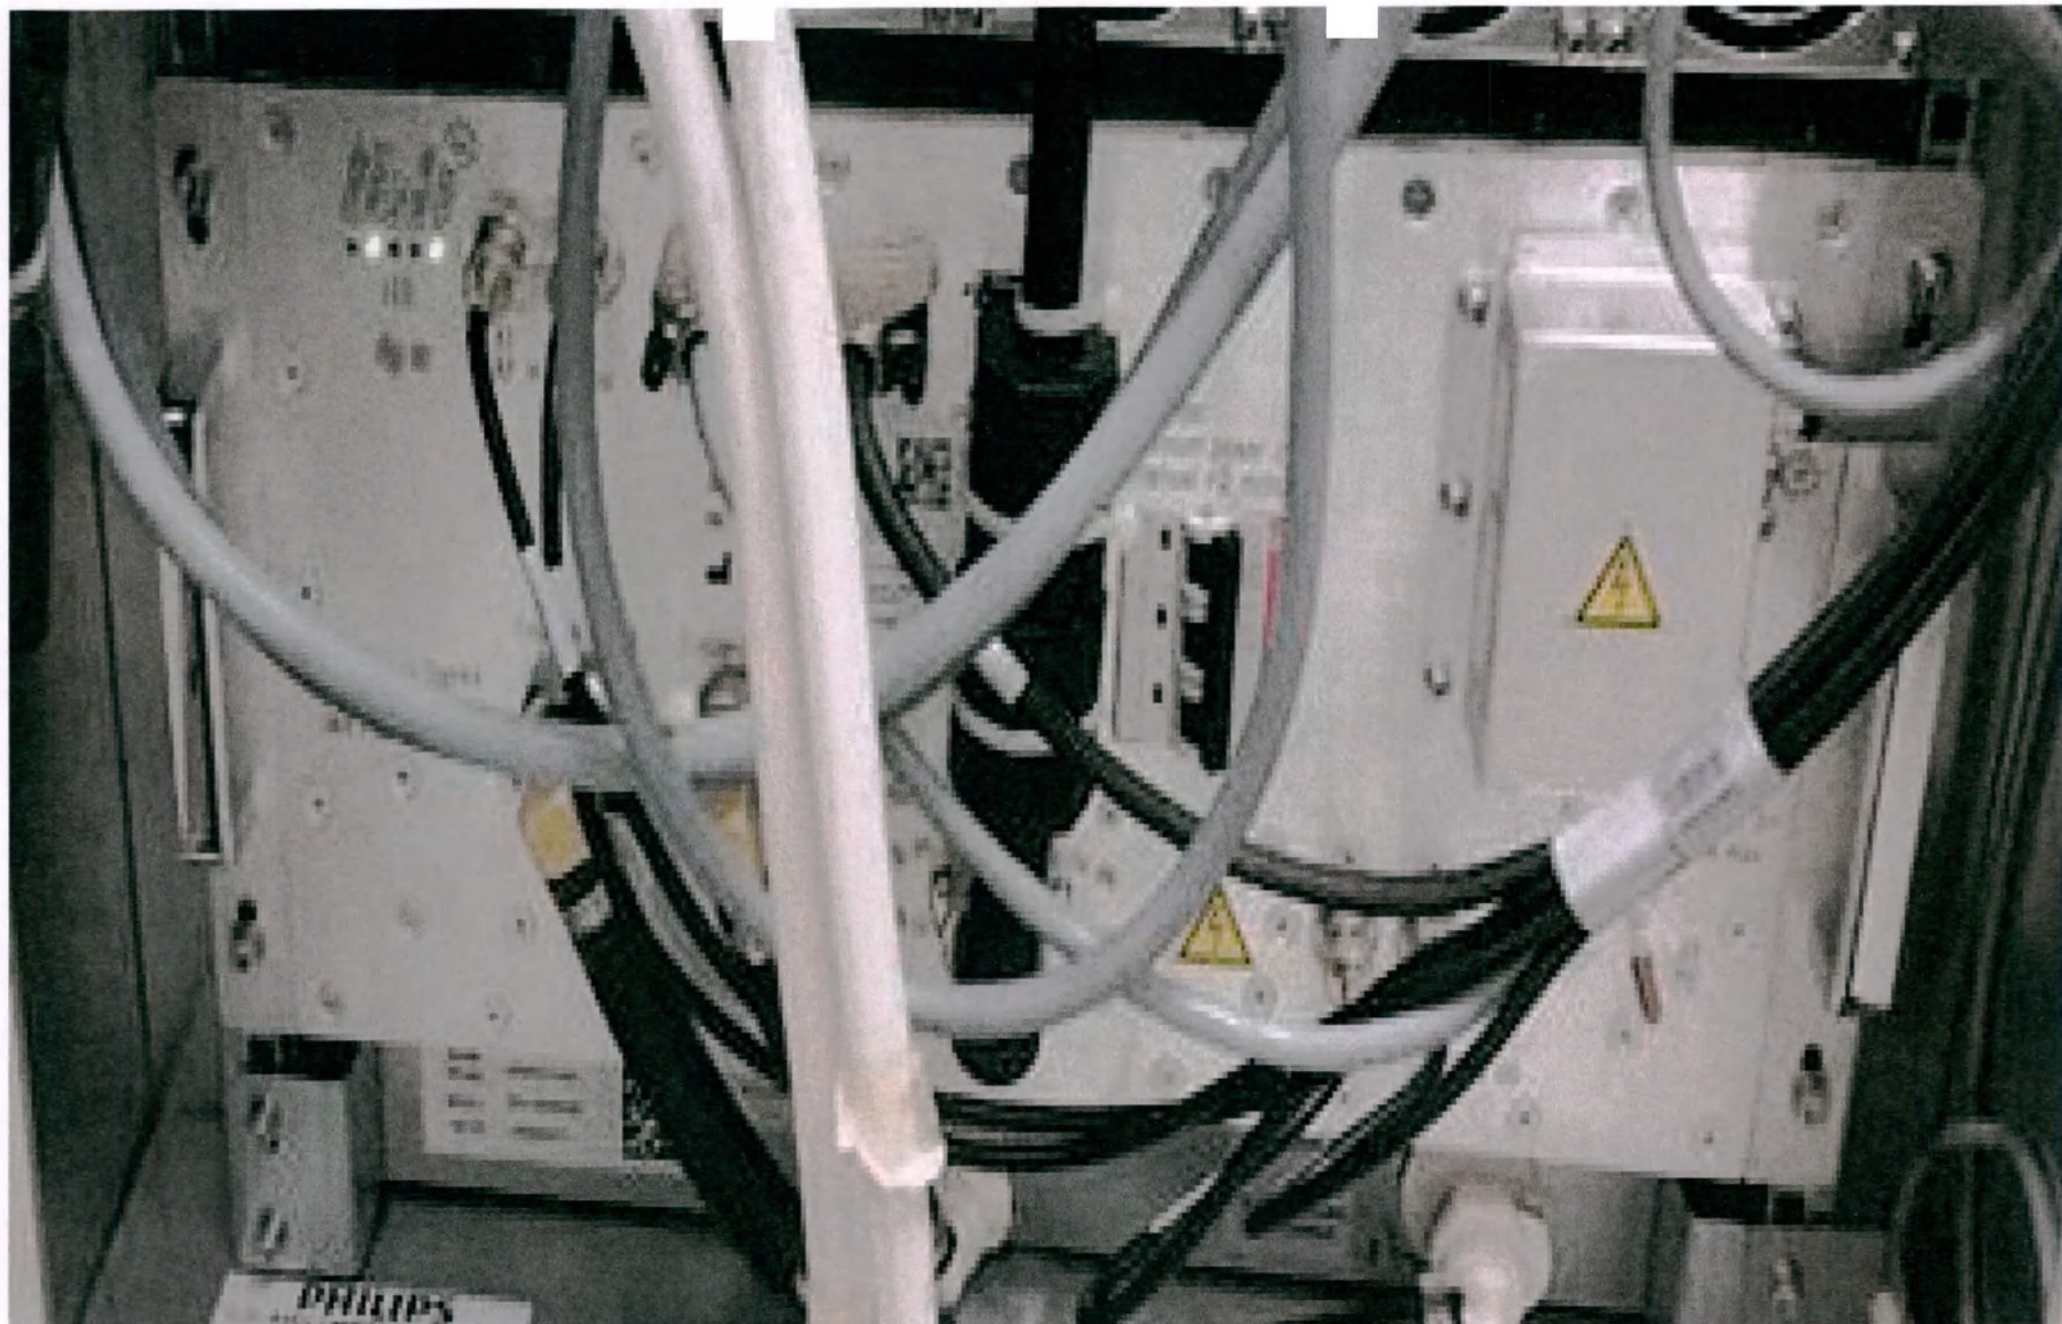


3. РЧ-усилитель.



4. Стол пациента.

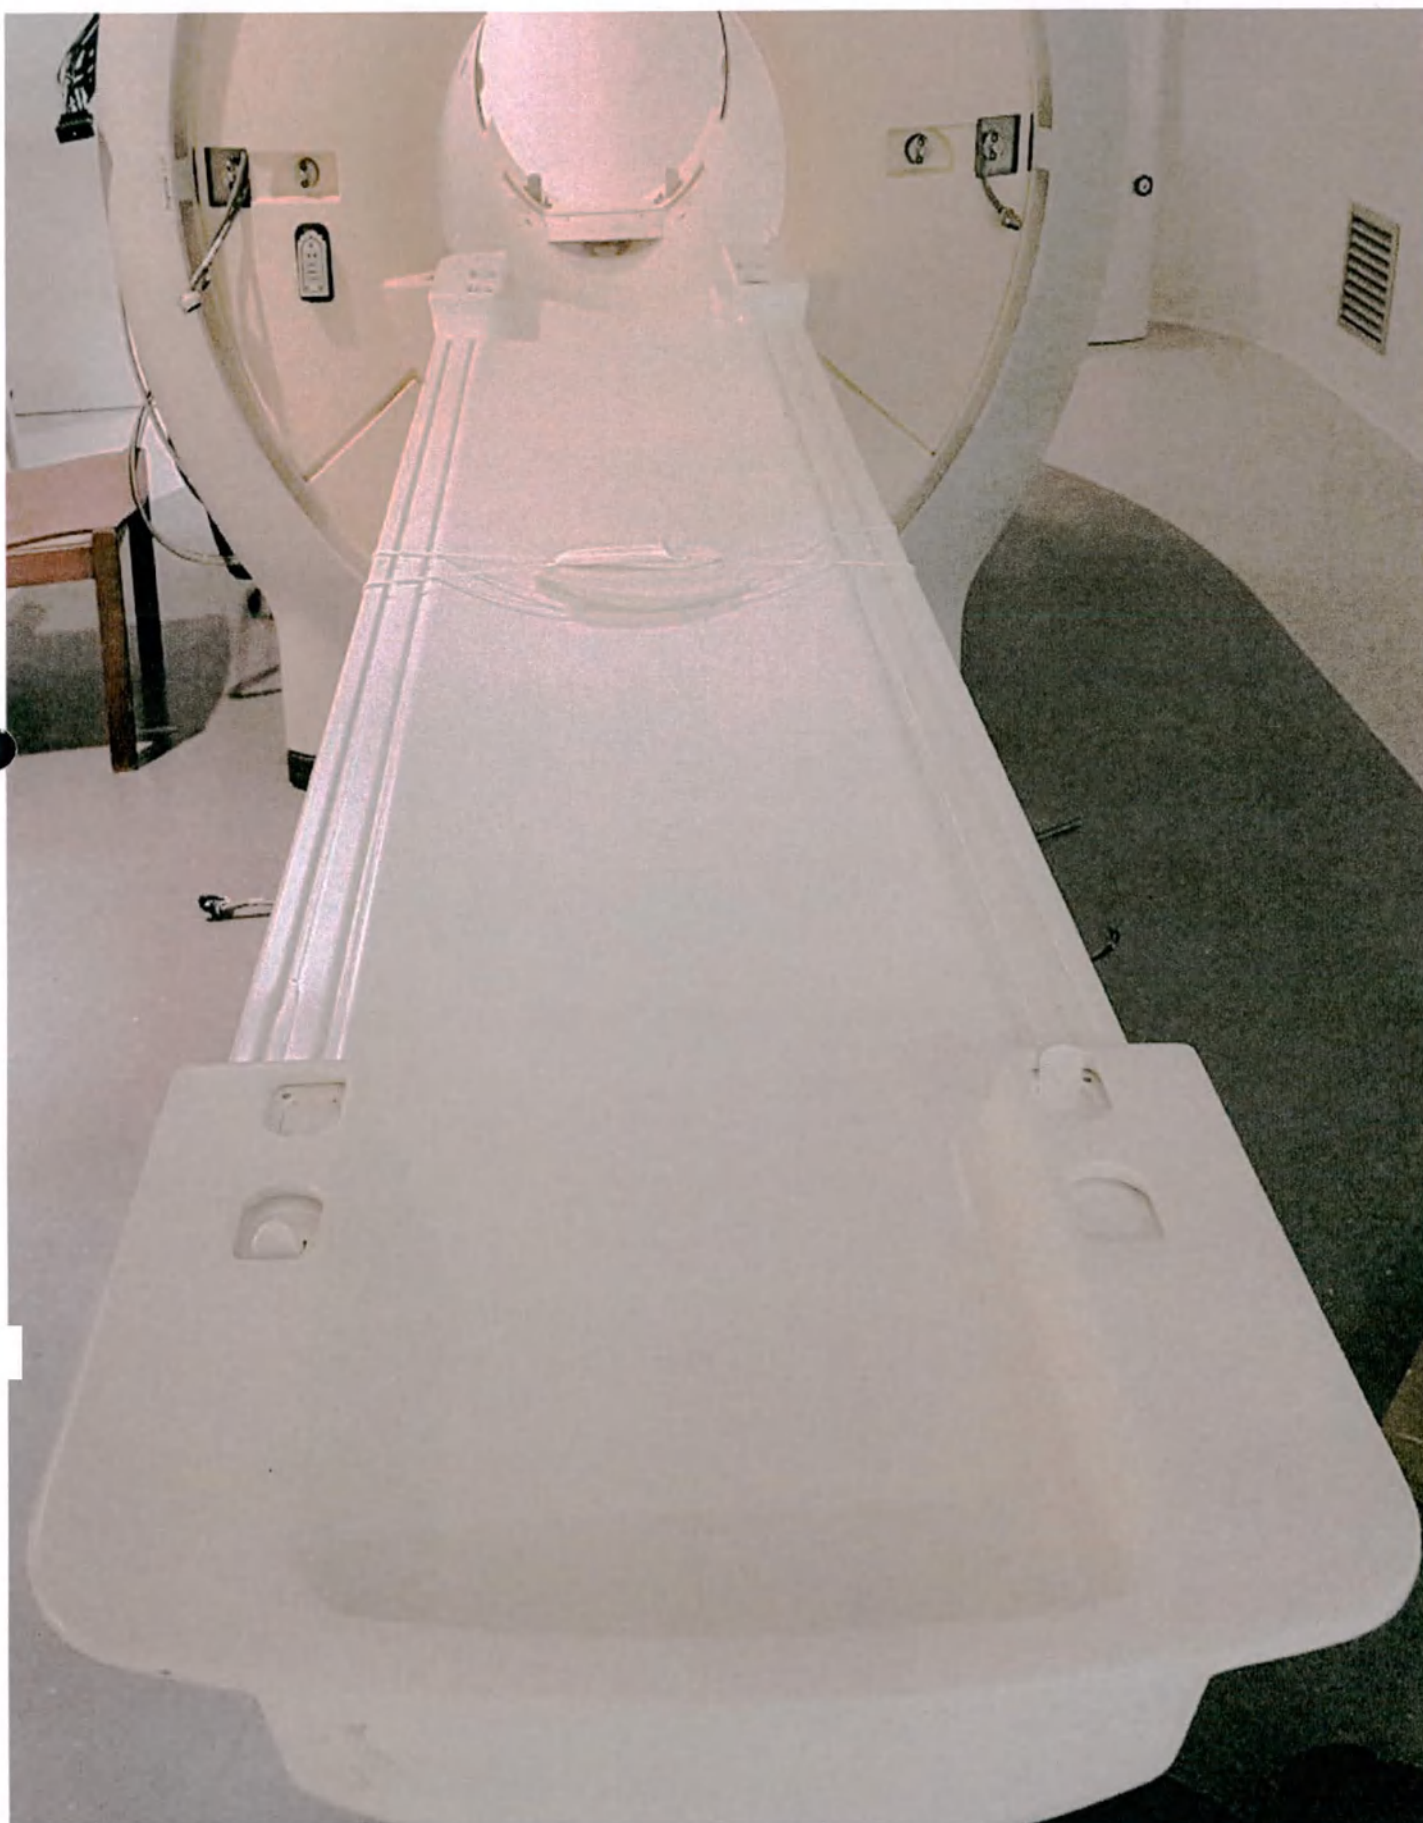

5. Дека стола тип 1.

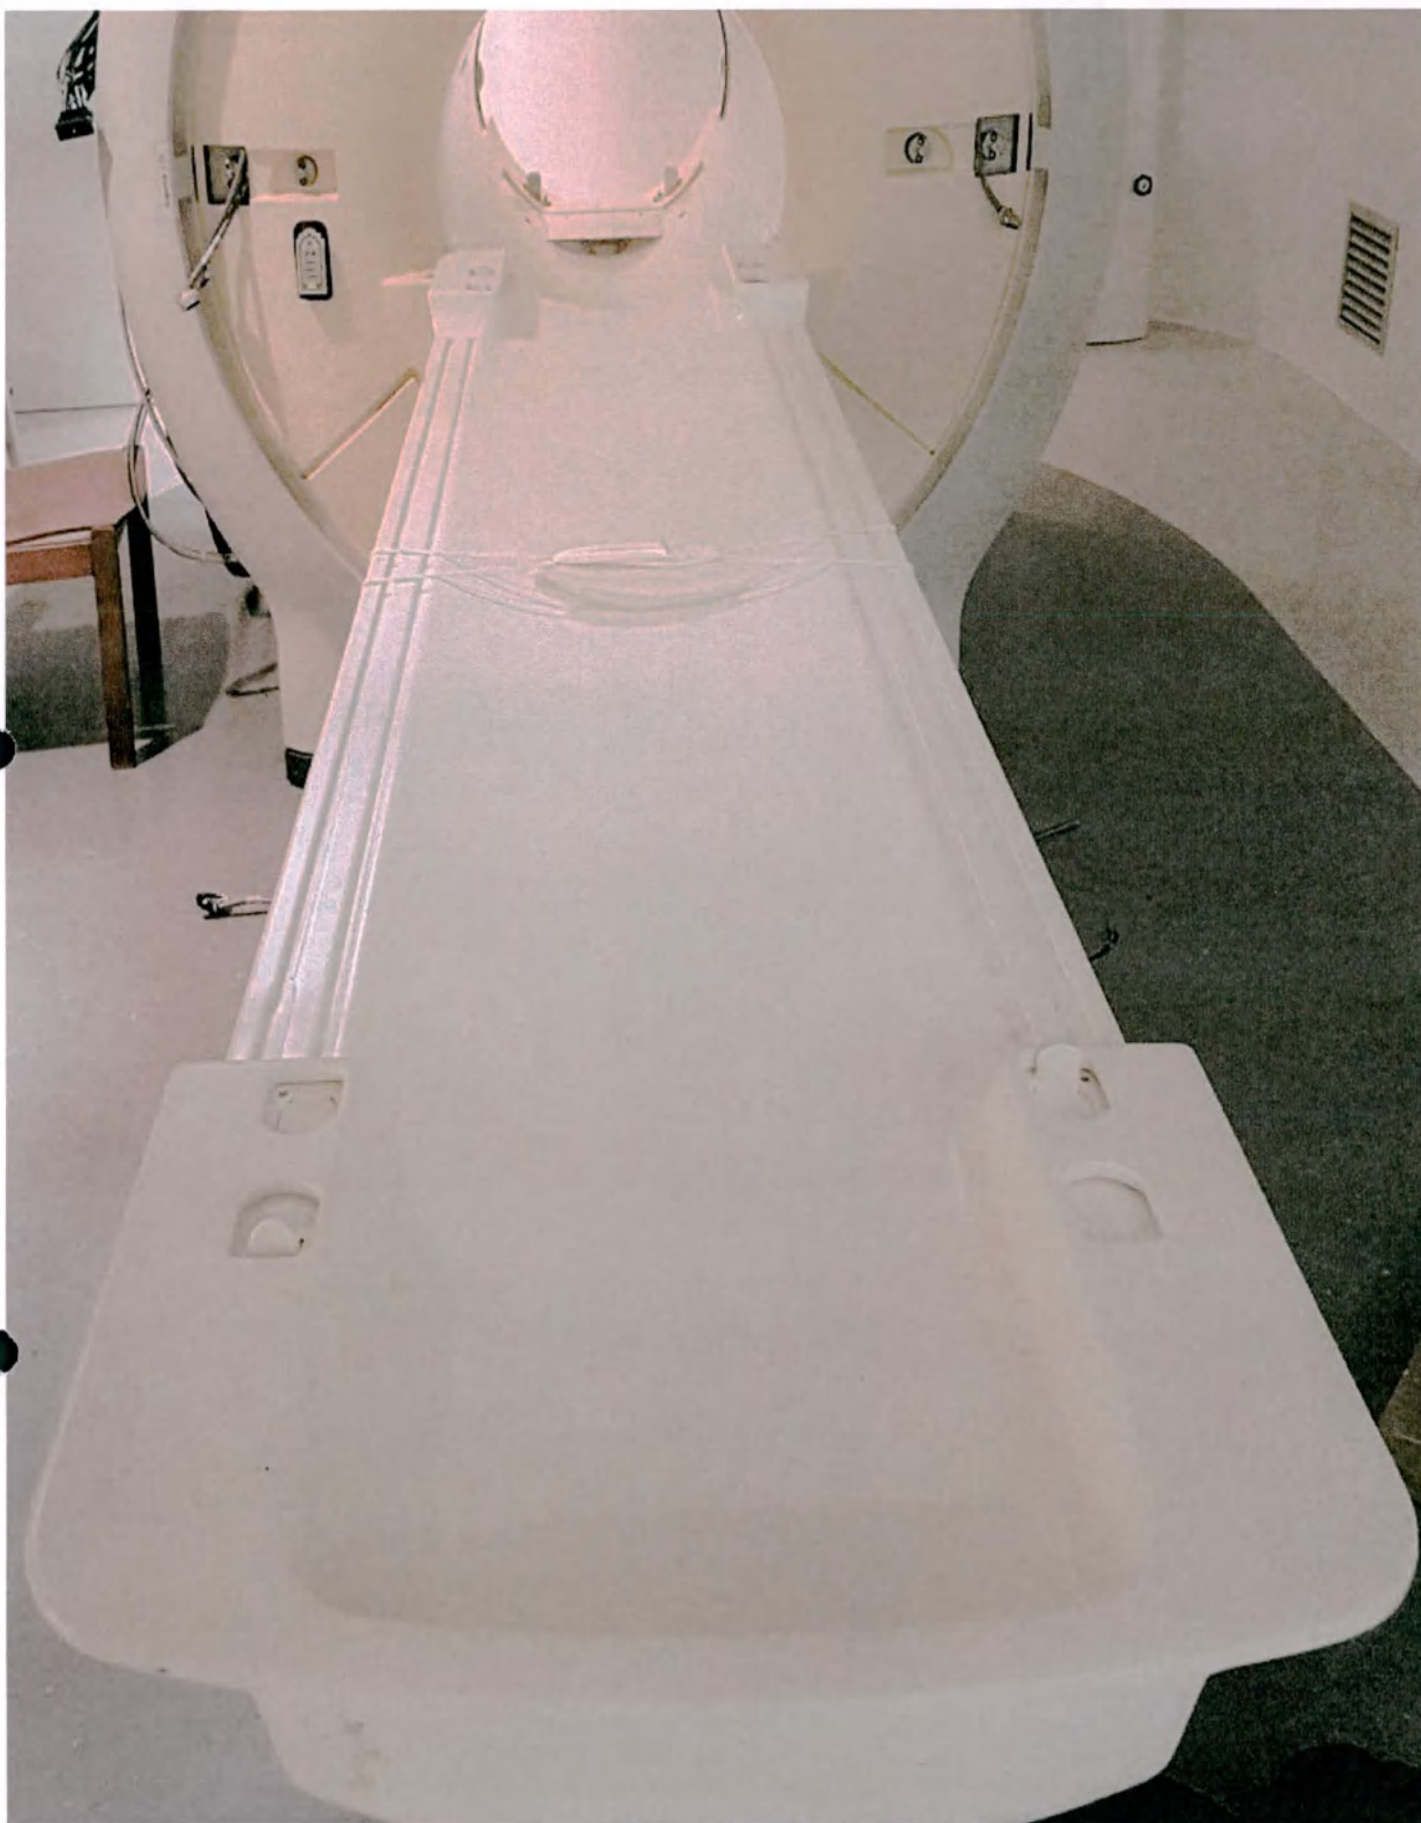

5. Дека стола тип 2.

6. РЧ-катушки:






6.2. Катюшка dS Head.




6.3. Катюшка dS HeadNeck.

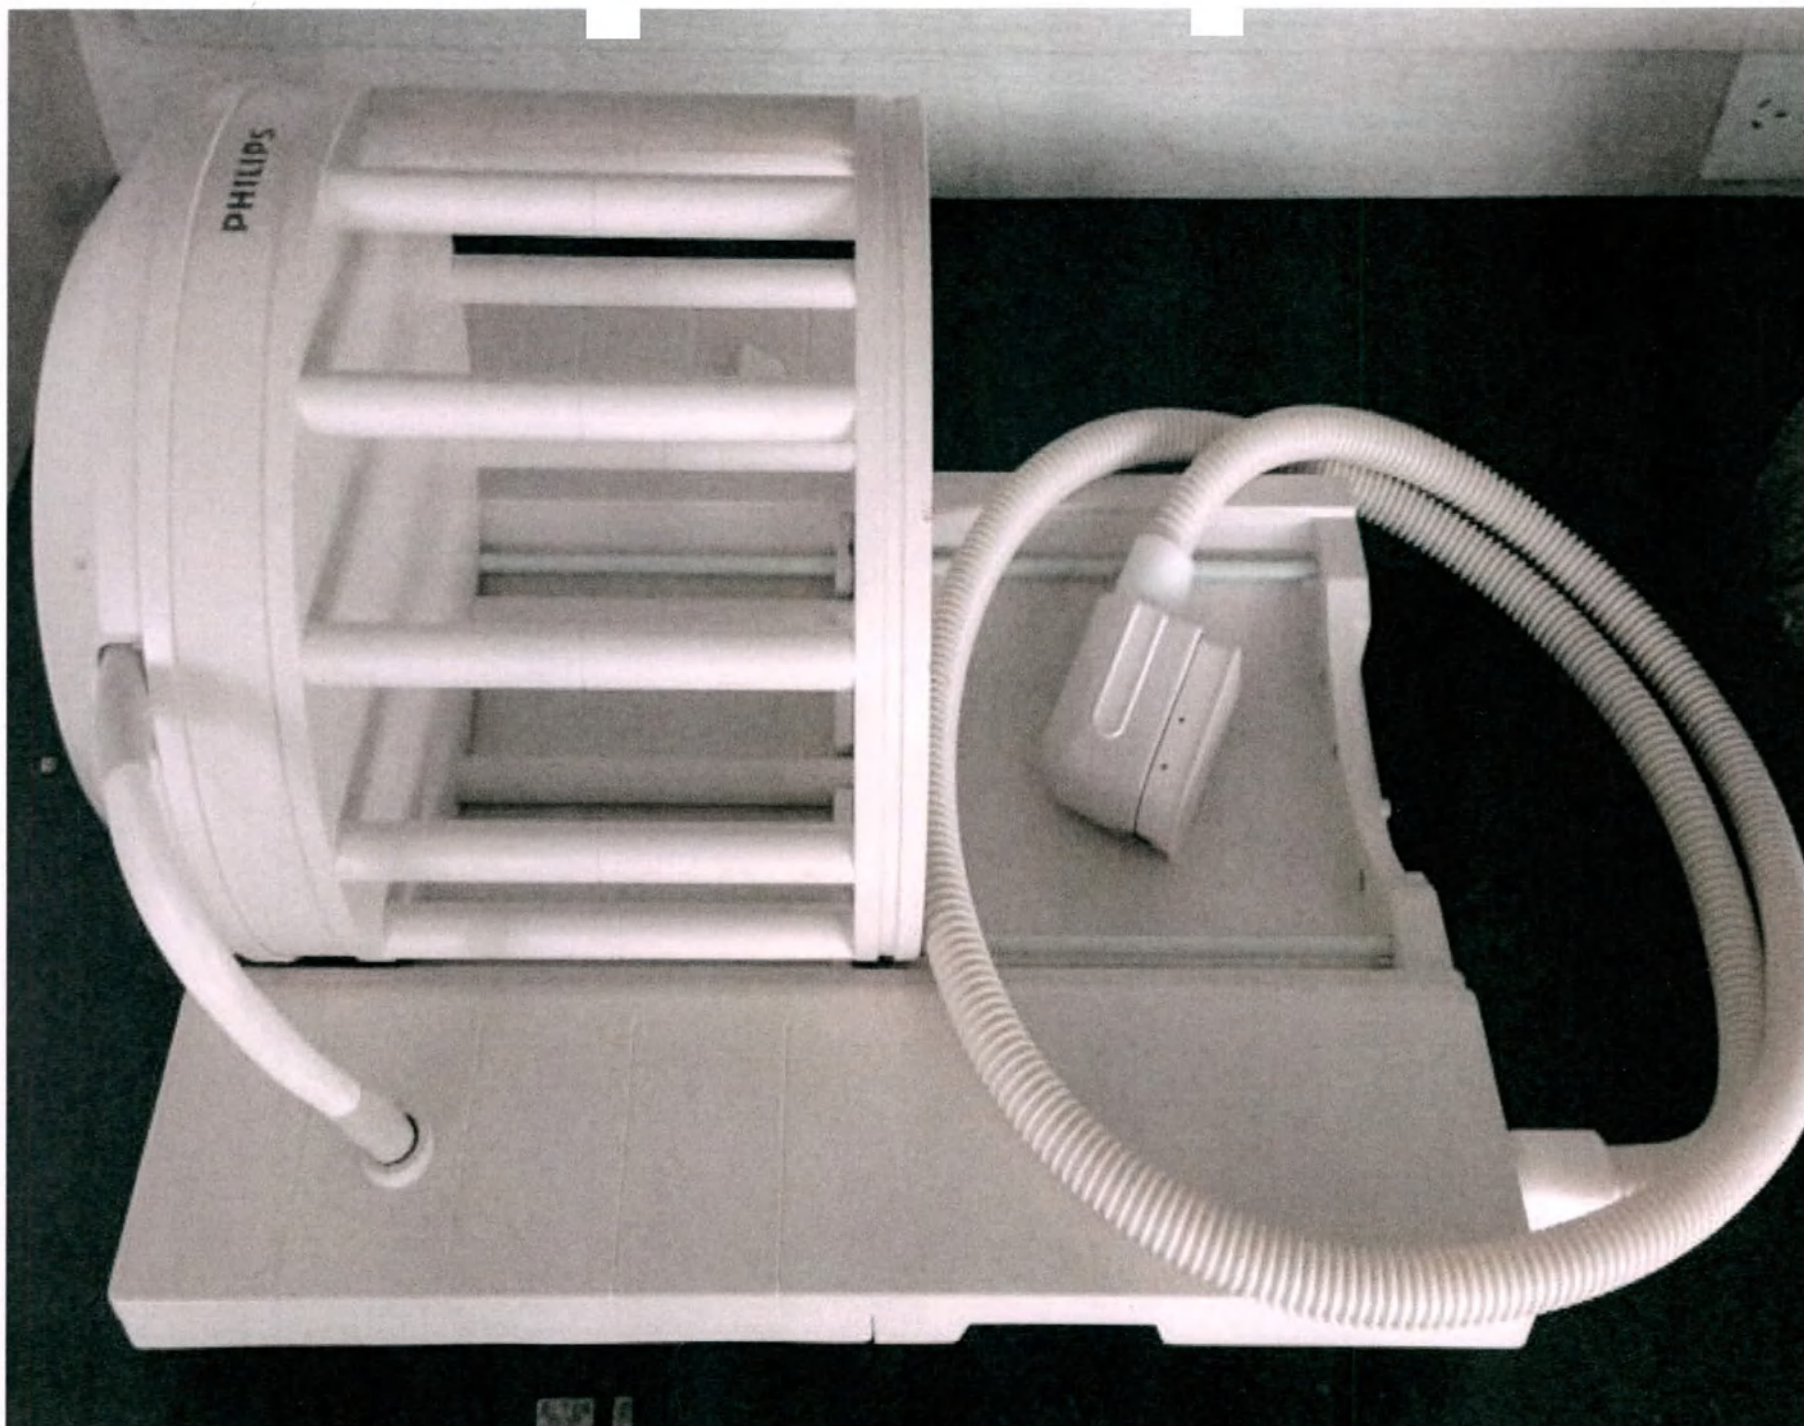

6.4. Катушка T/R Head.




6.5. Катюшка dS Torso.

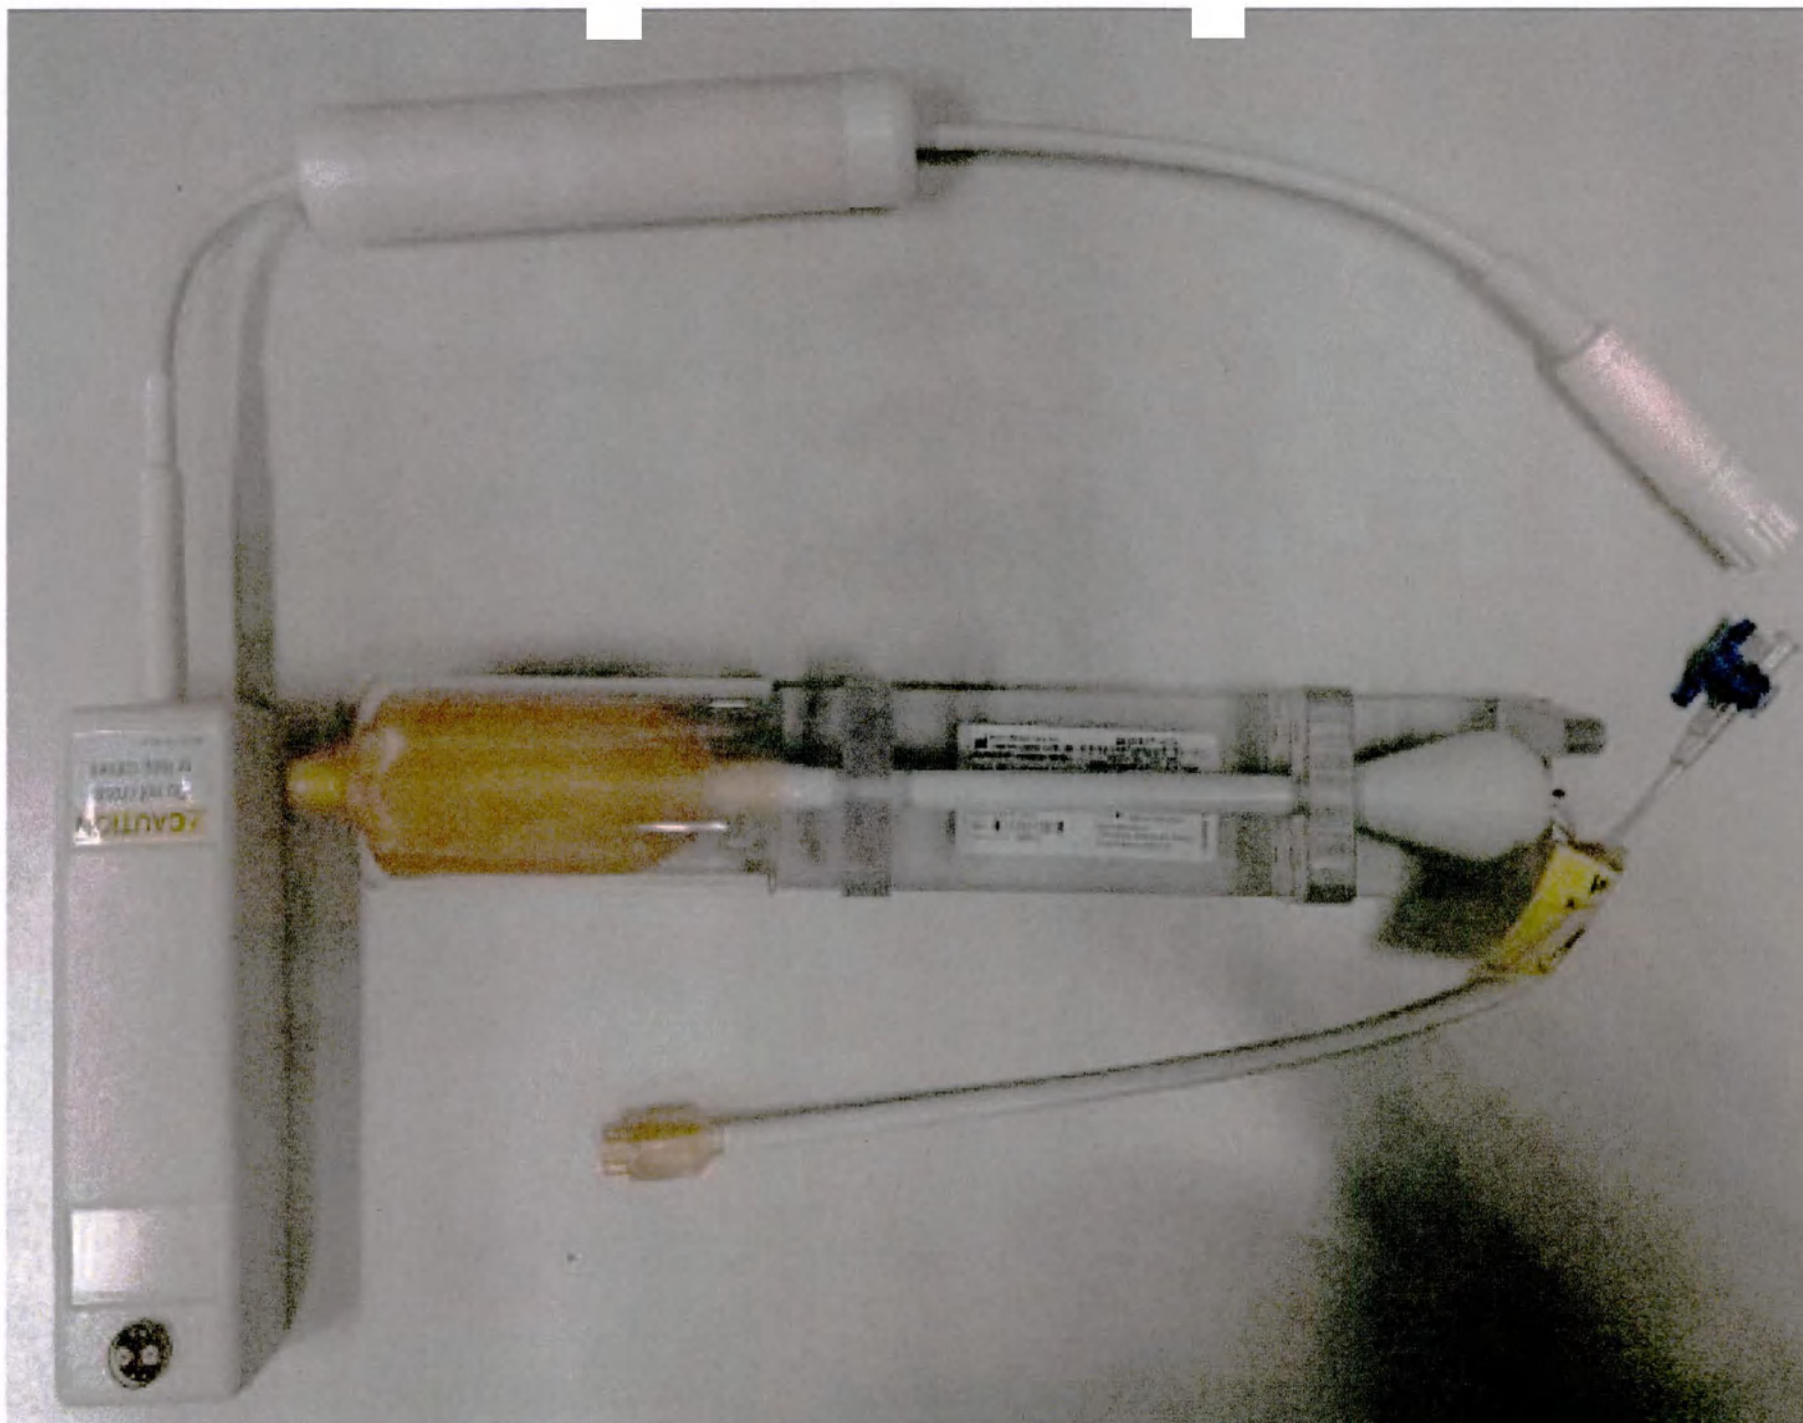

6.6. Катюшка dS Endo 1.5T.




6.7. 16-канальная катушка dS Breast.




6.8. 7-канальная катушка dS Breast.



6.8.1.2. Опора для рук
6.8.1.3. Опора для головы

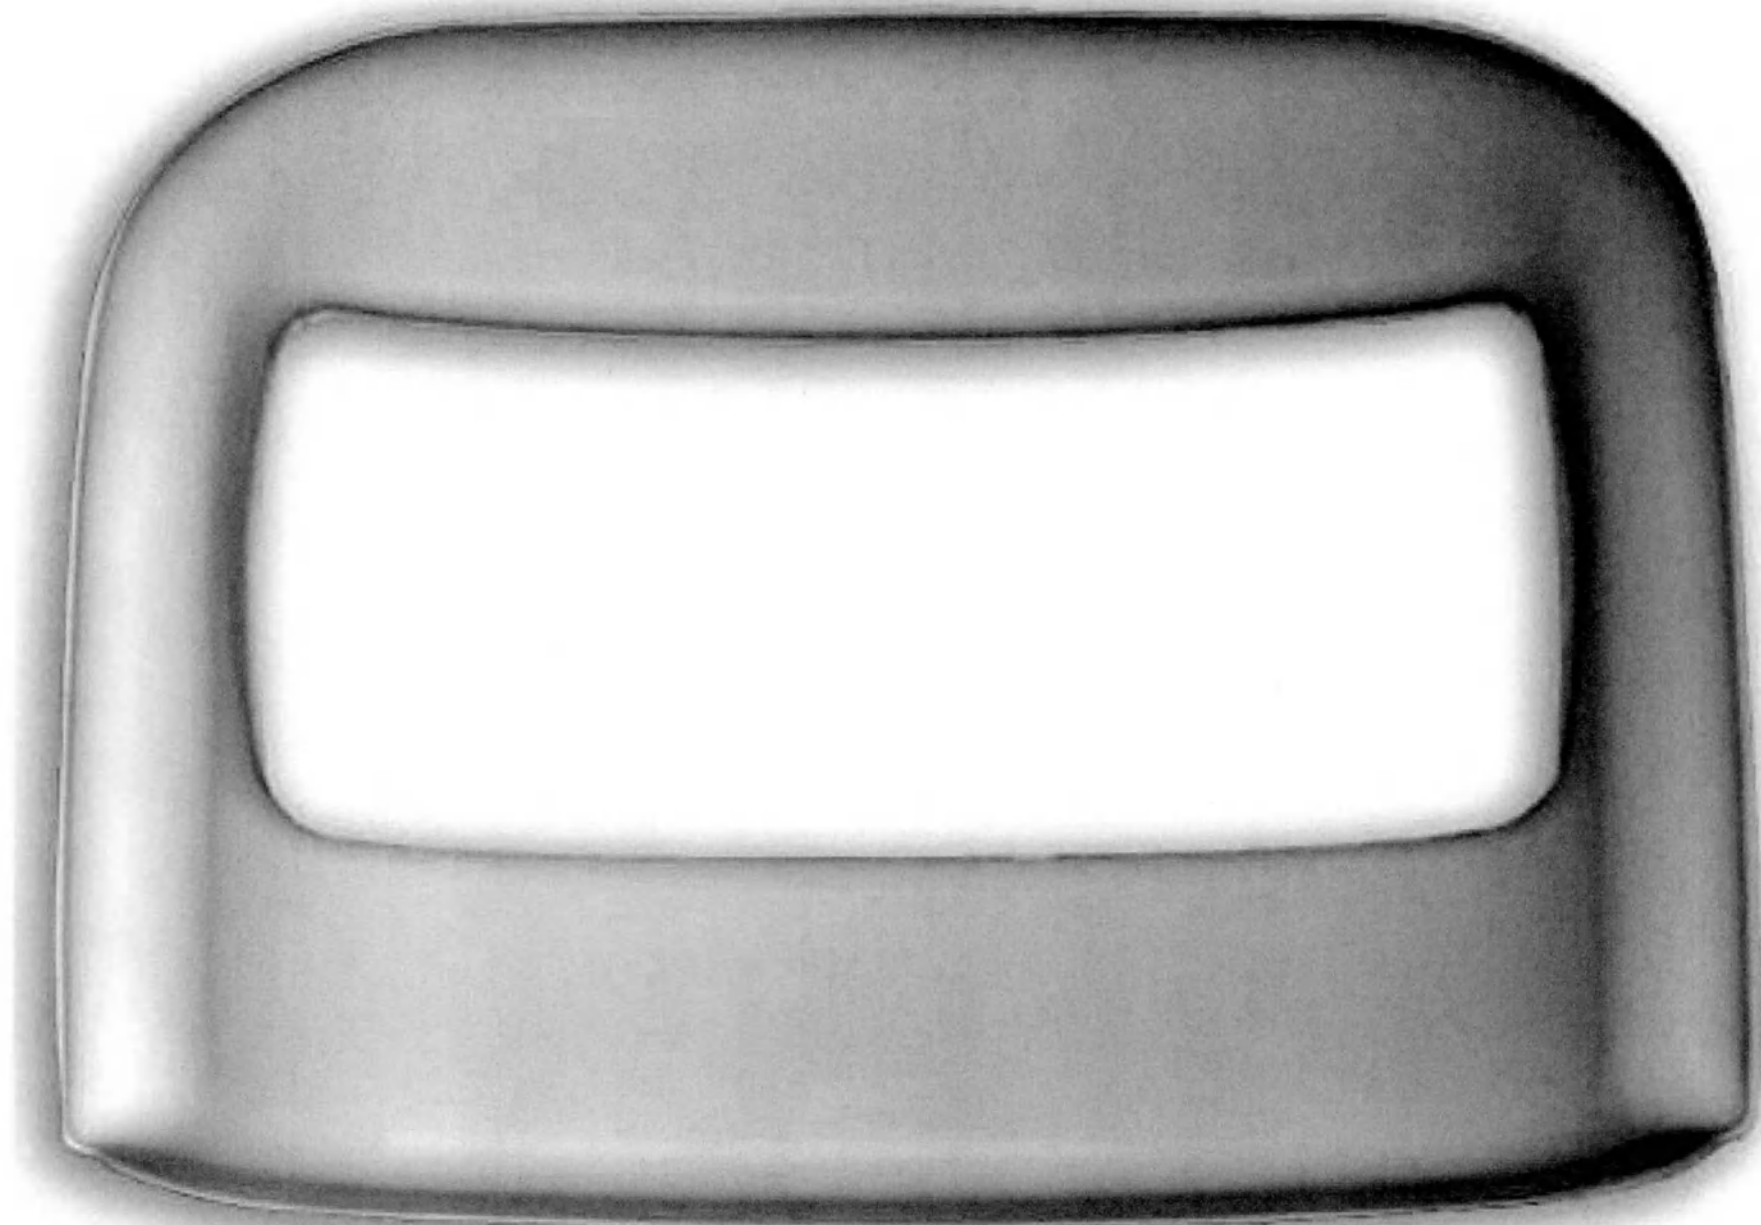

6.8.1.4. Верхняя прокладка для грудной катушки

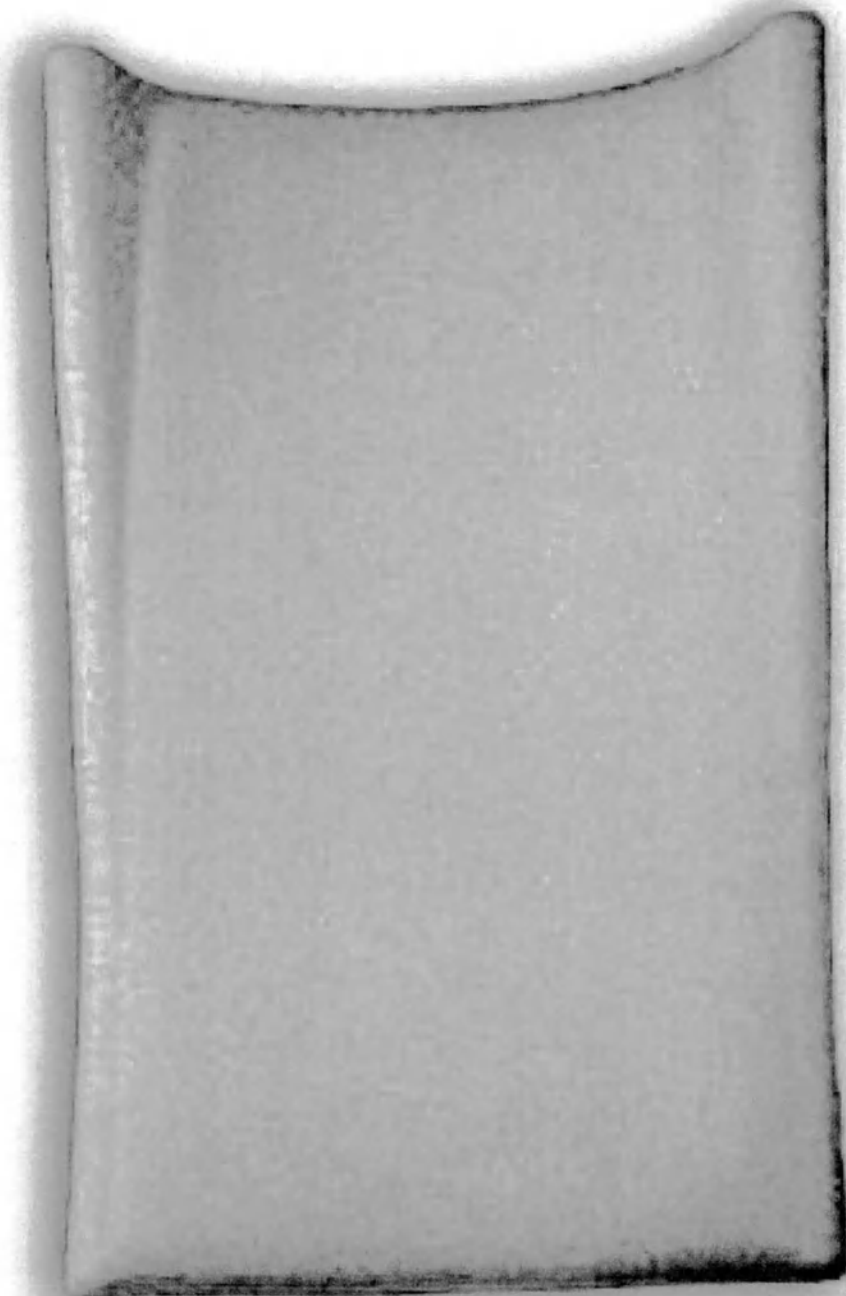

6.8.1.5. Опора на липучках снизу (слева: вид сверху, справа: вид снизу)



6.8.1.6. Надставка опоры с углублением для кабелей




6.9. Катушка dS Flex S.




6.10. Катушка dS Flex M.



6.11. Катушка dS Flex L.

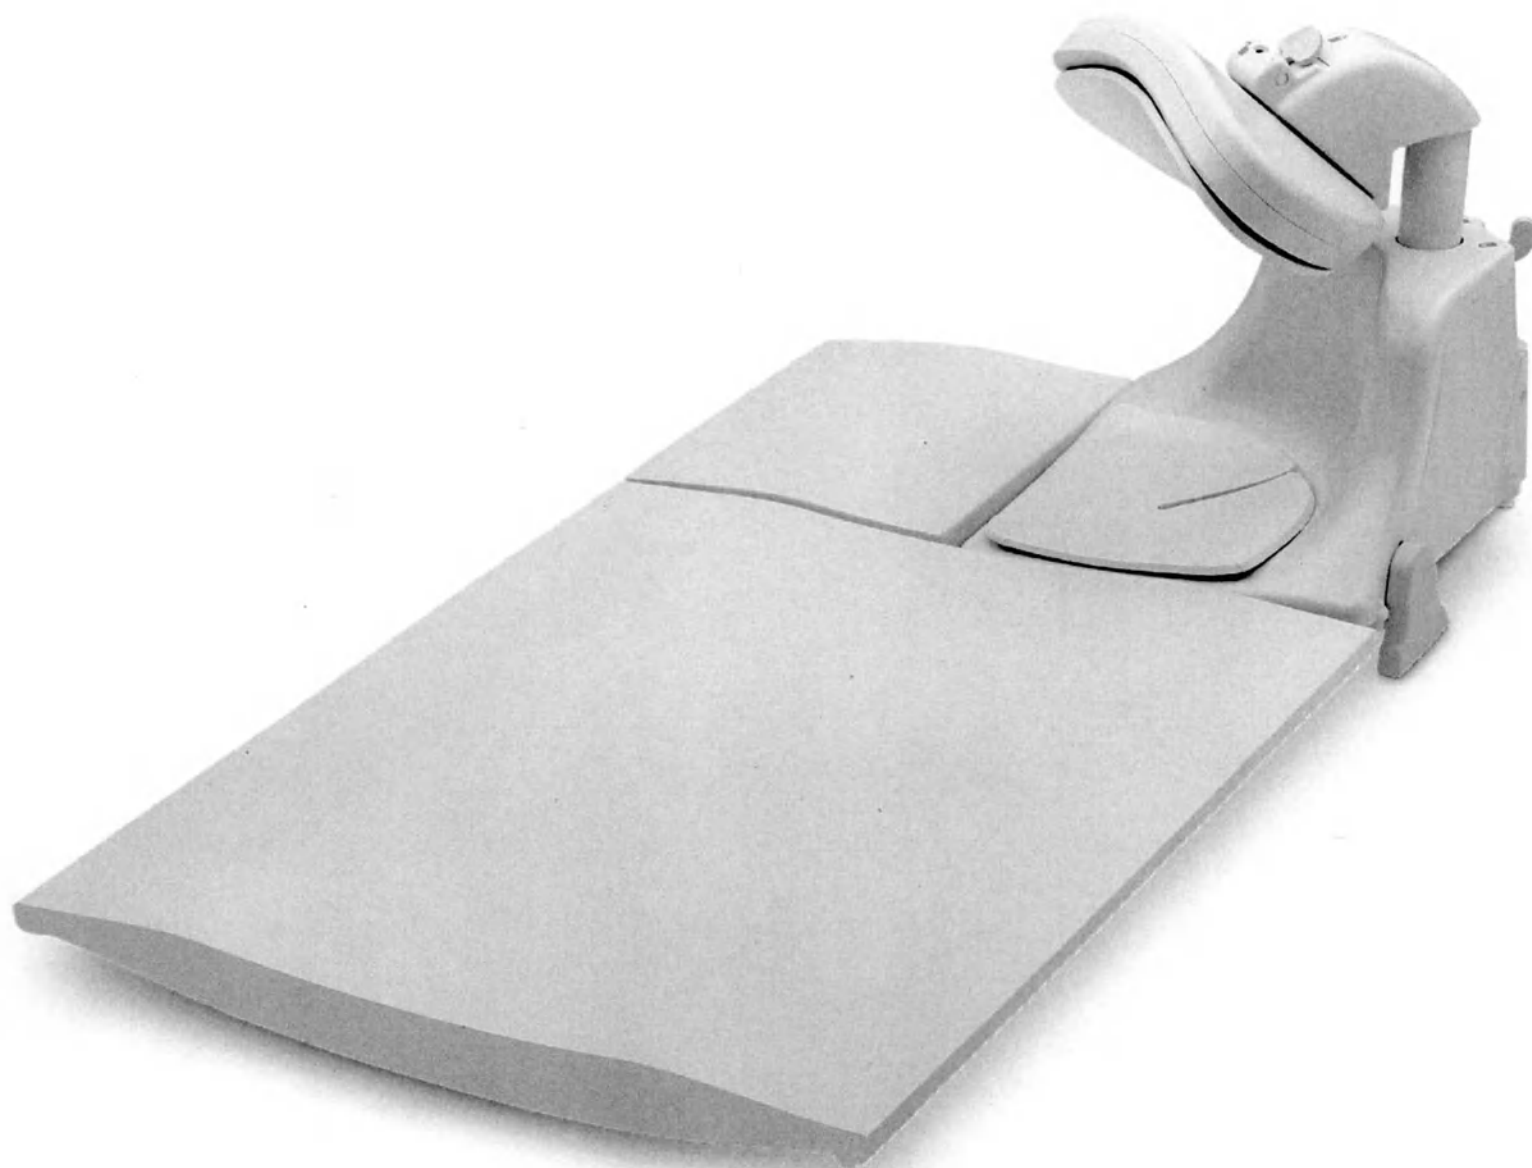

6.12. Катушка dS Shoulder 16ch.

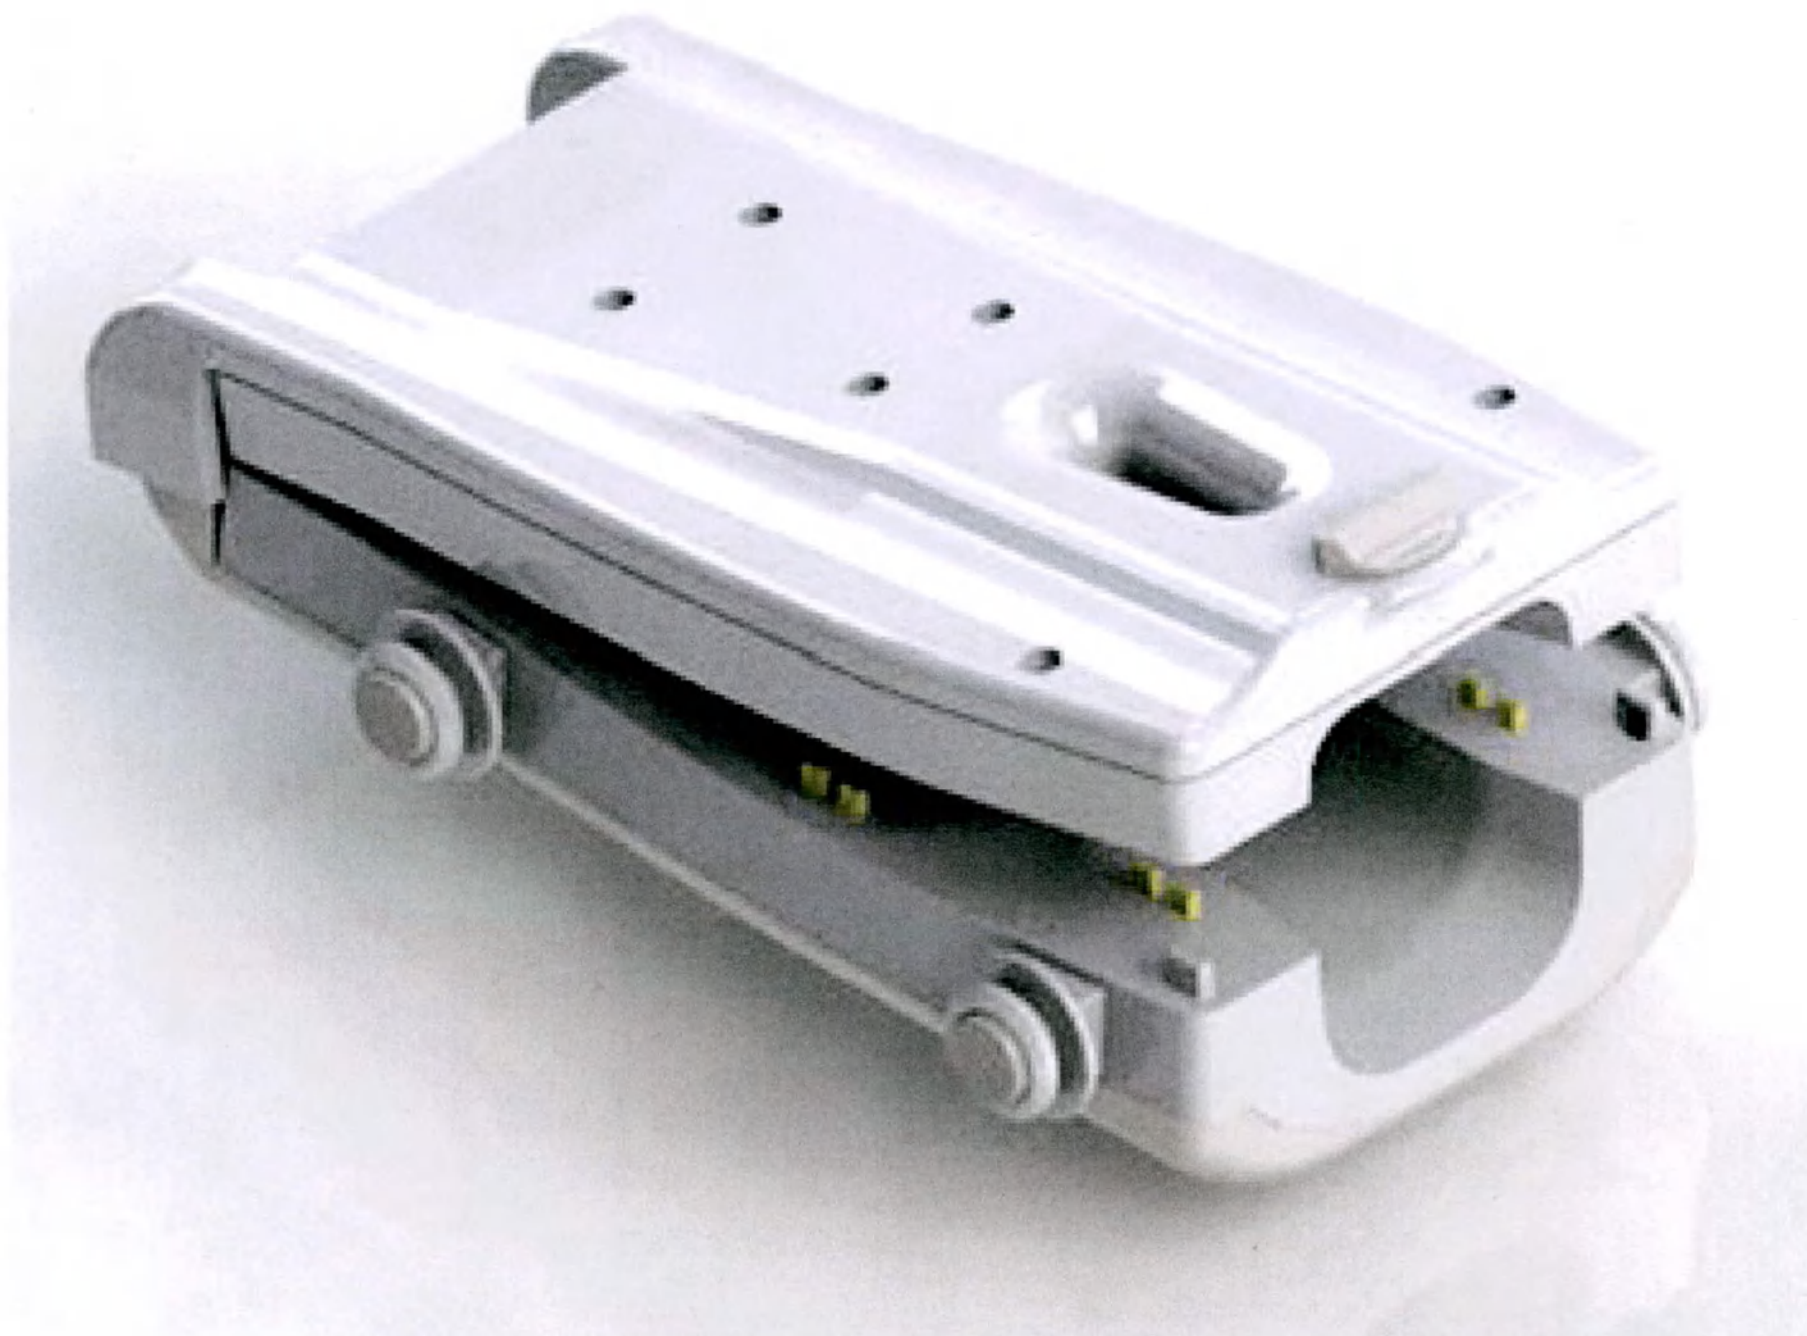

6.13. Катушка dS HandWrist 16ch.




6.14. 16-канальная катушка dS Knee.



6.15. 16-канальная катушка dS T/R Кнее.




6.16. Катусшка dS FootAnkle 16ch.

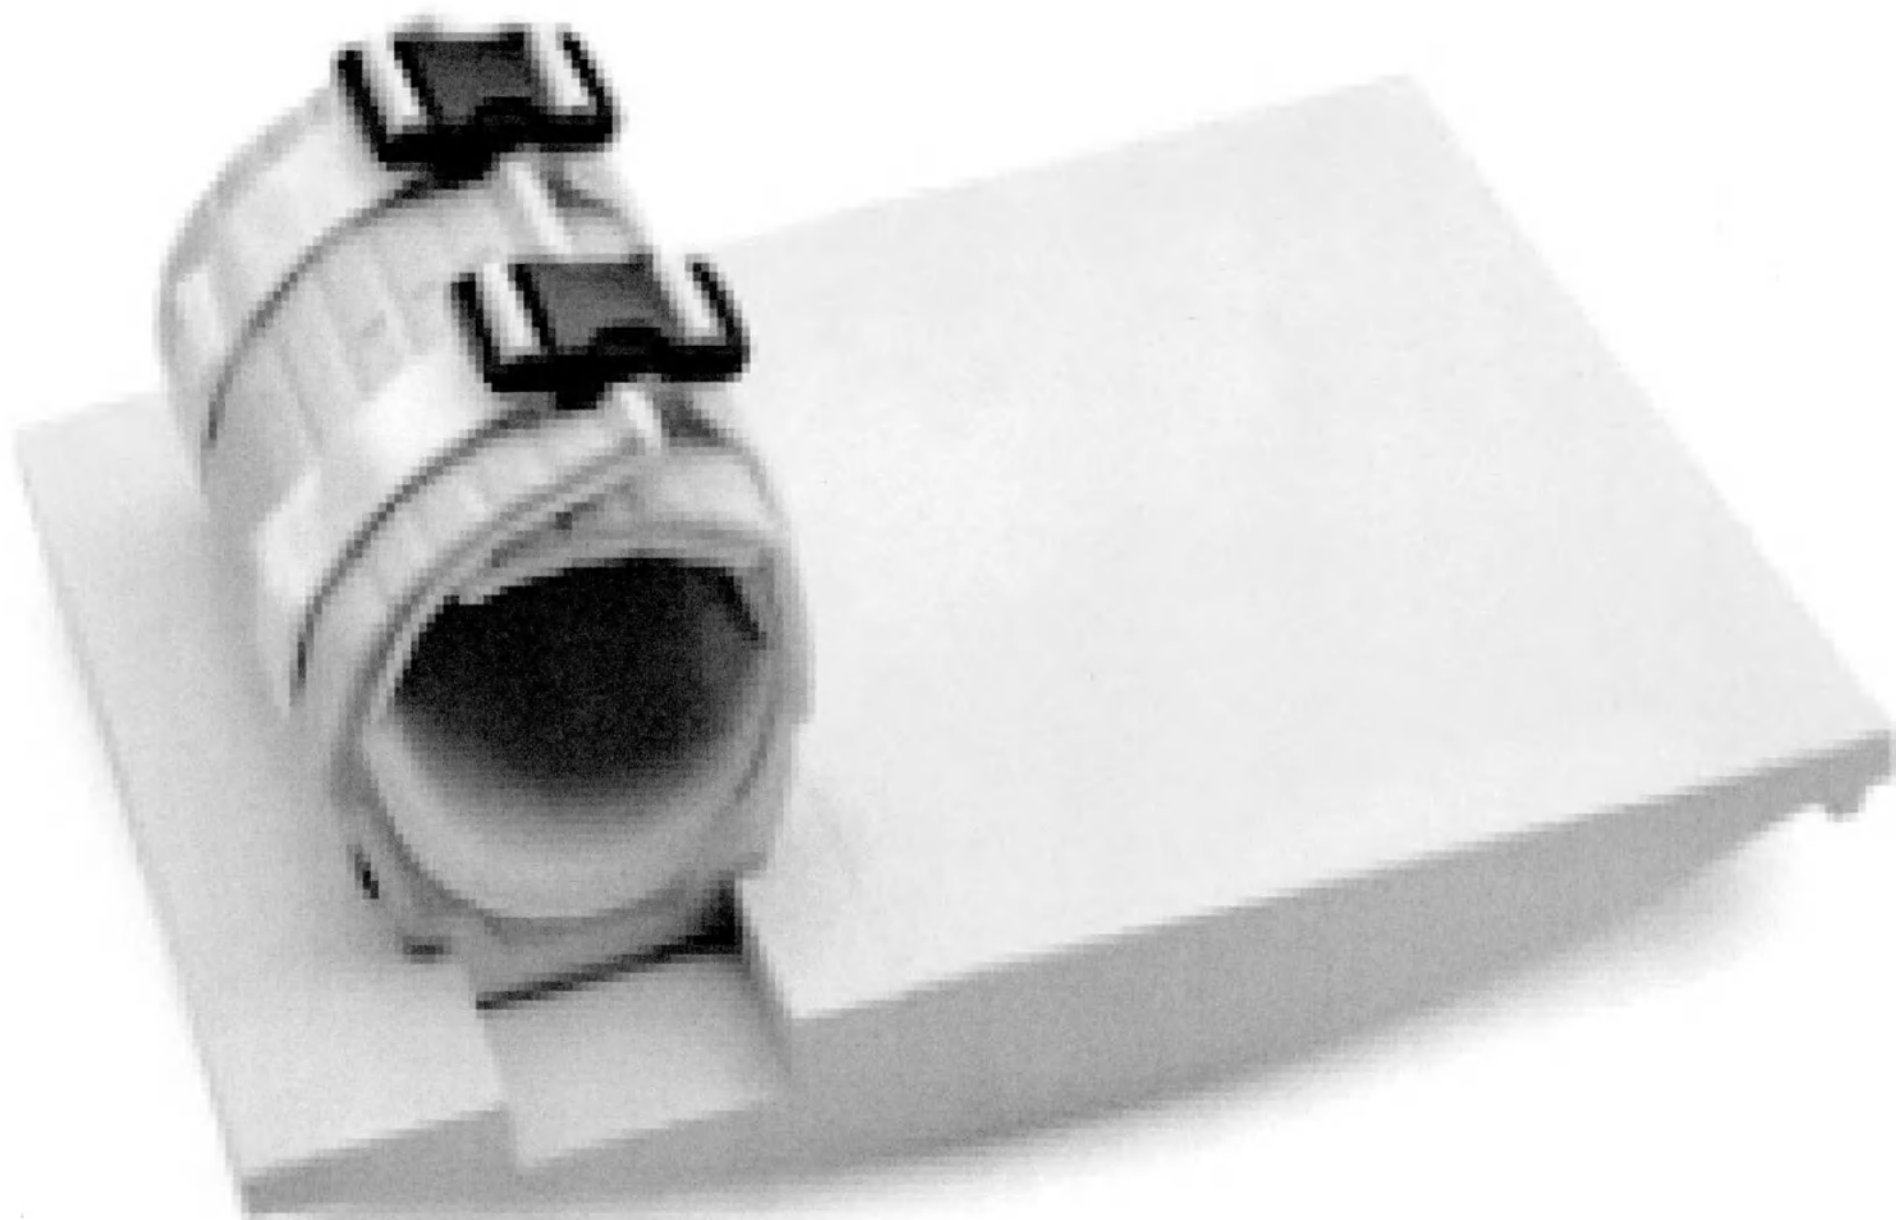


6.17. Катушка dS SmallExtremity 16ch.



6.18. Катушка dS Pediatric Head-Spine 8ch.

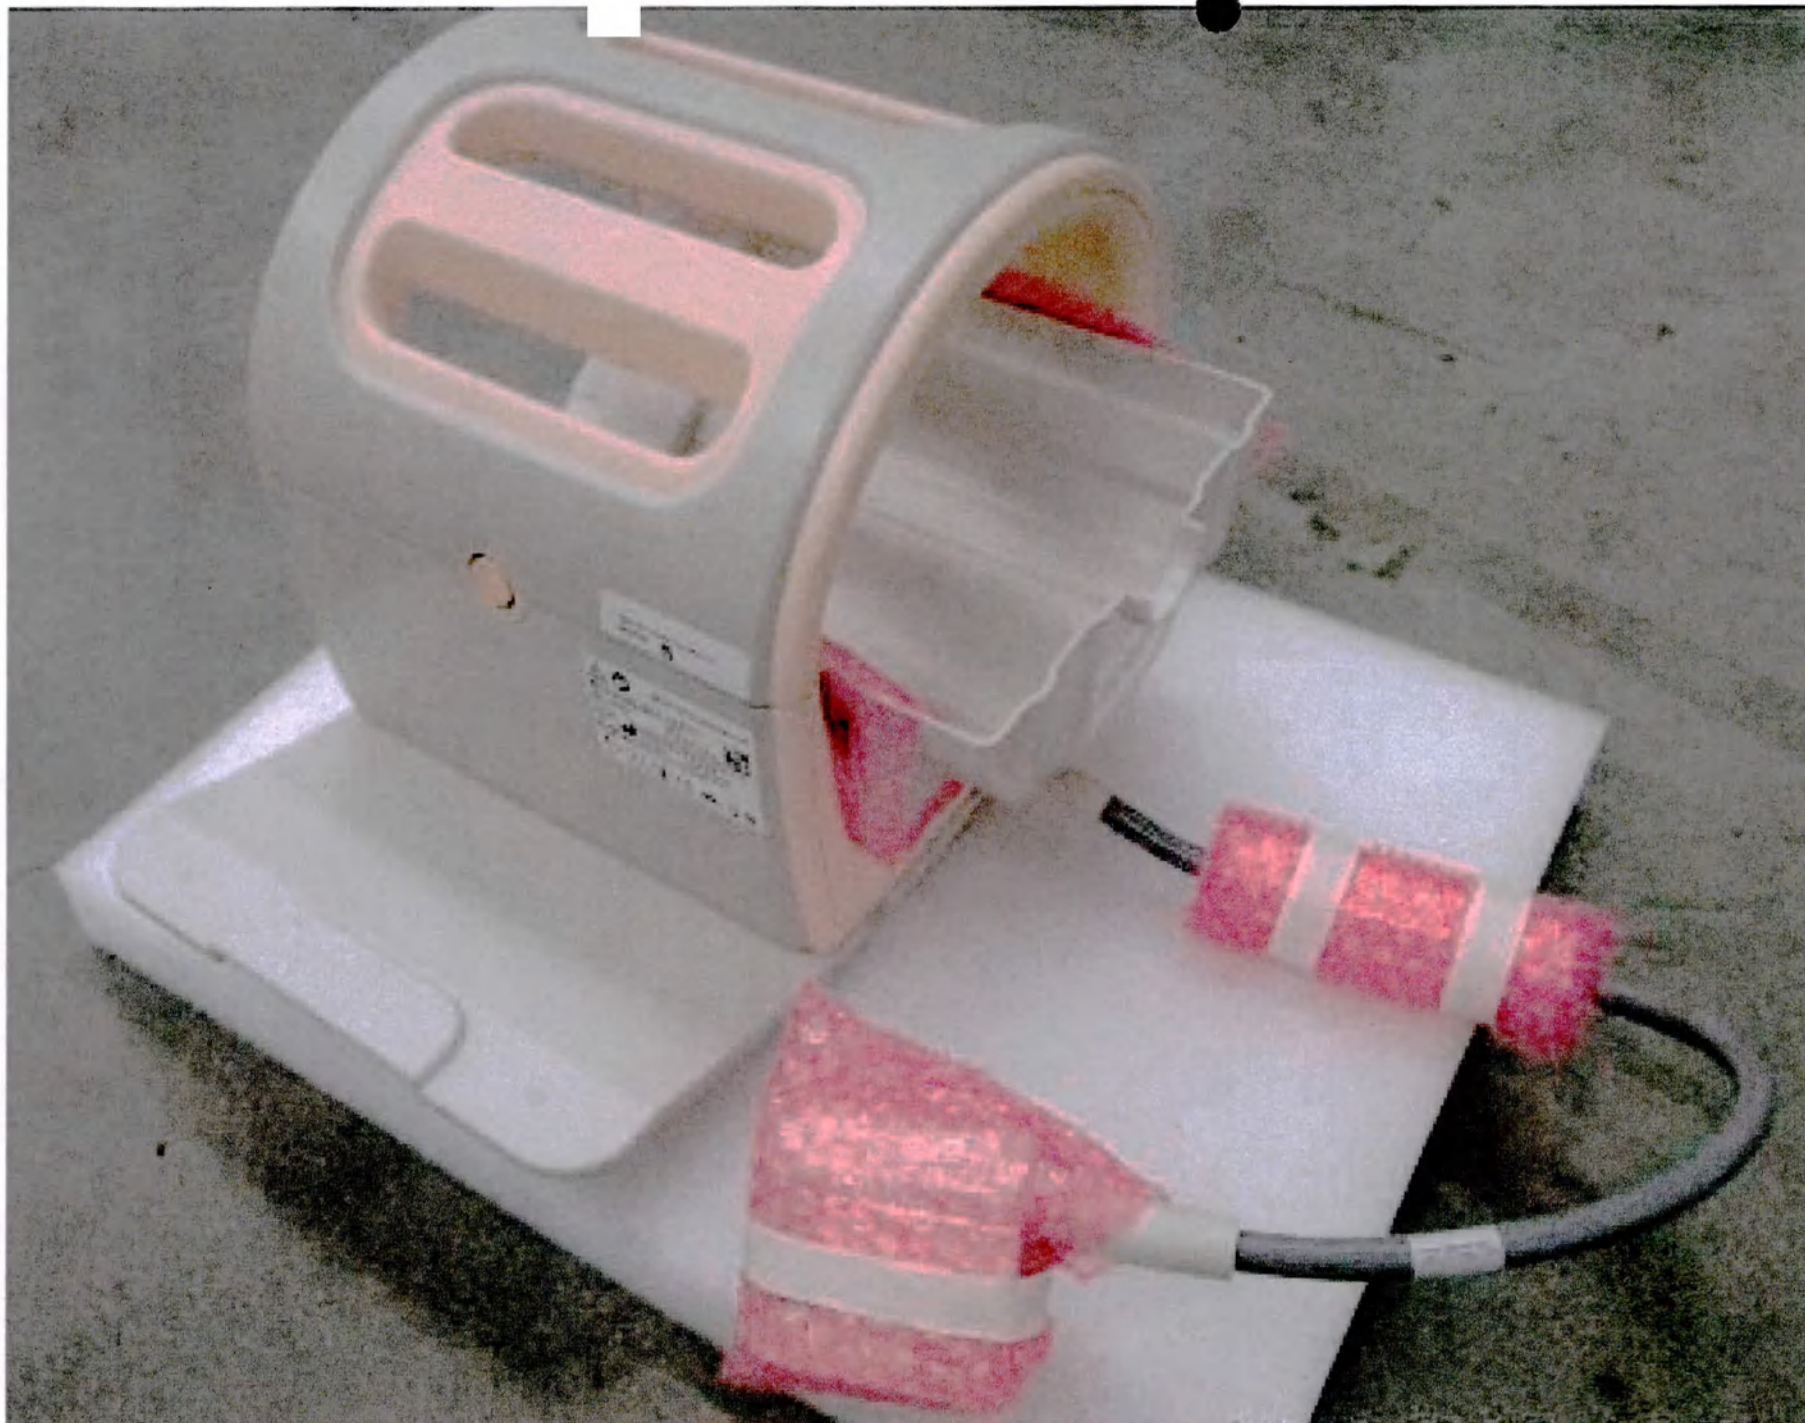

6.19. Катетер dS Pediatric Body-Cardiac 8ch.

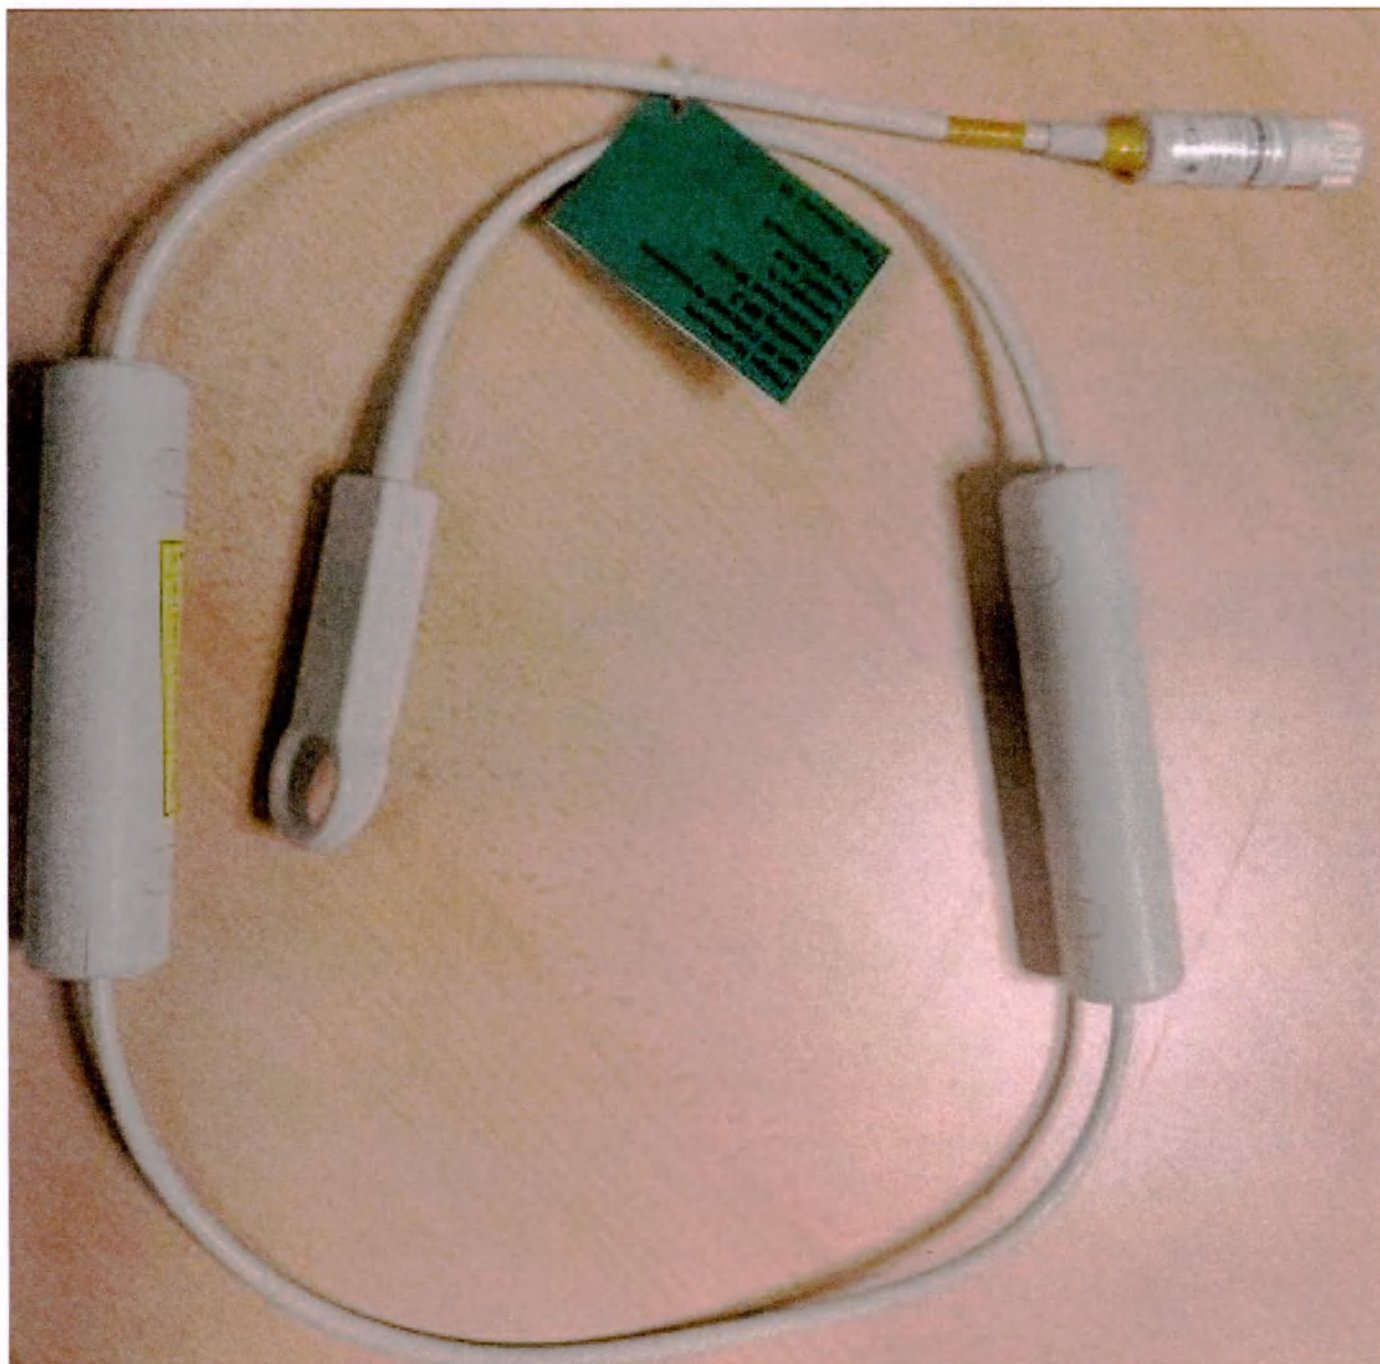


6.20 Катушка dS Microscopy, в вариантах исполнения: 23 мм и/или 47 мм (вариант исполнения 23 мм).




6.20 Катушка dS Microscopy, в вариантах исполнения: 23 мм и/или 47 мм (вариант исполнения 47 мм).



7. Модуль пользовательского интерфейса UIM.

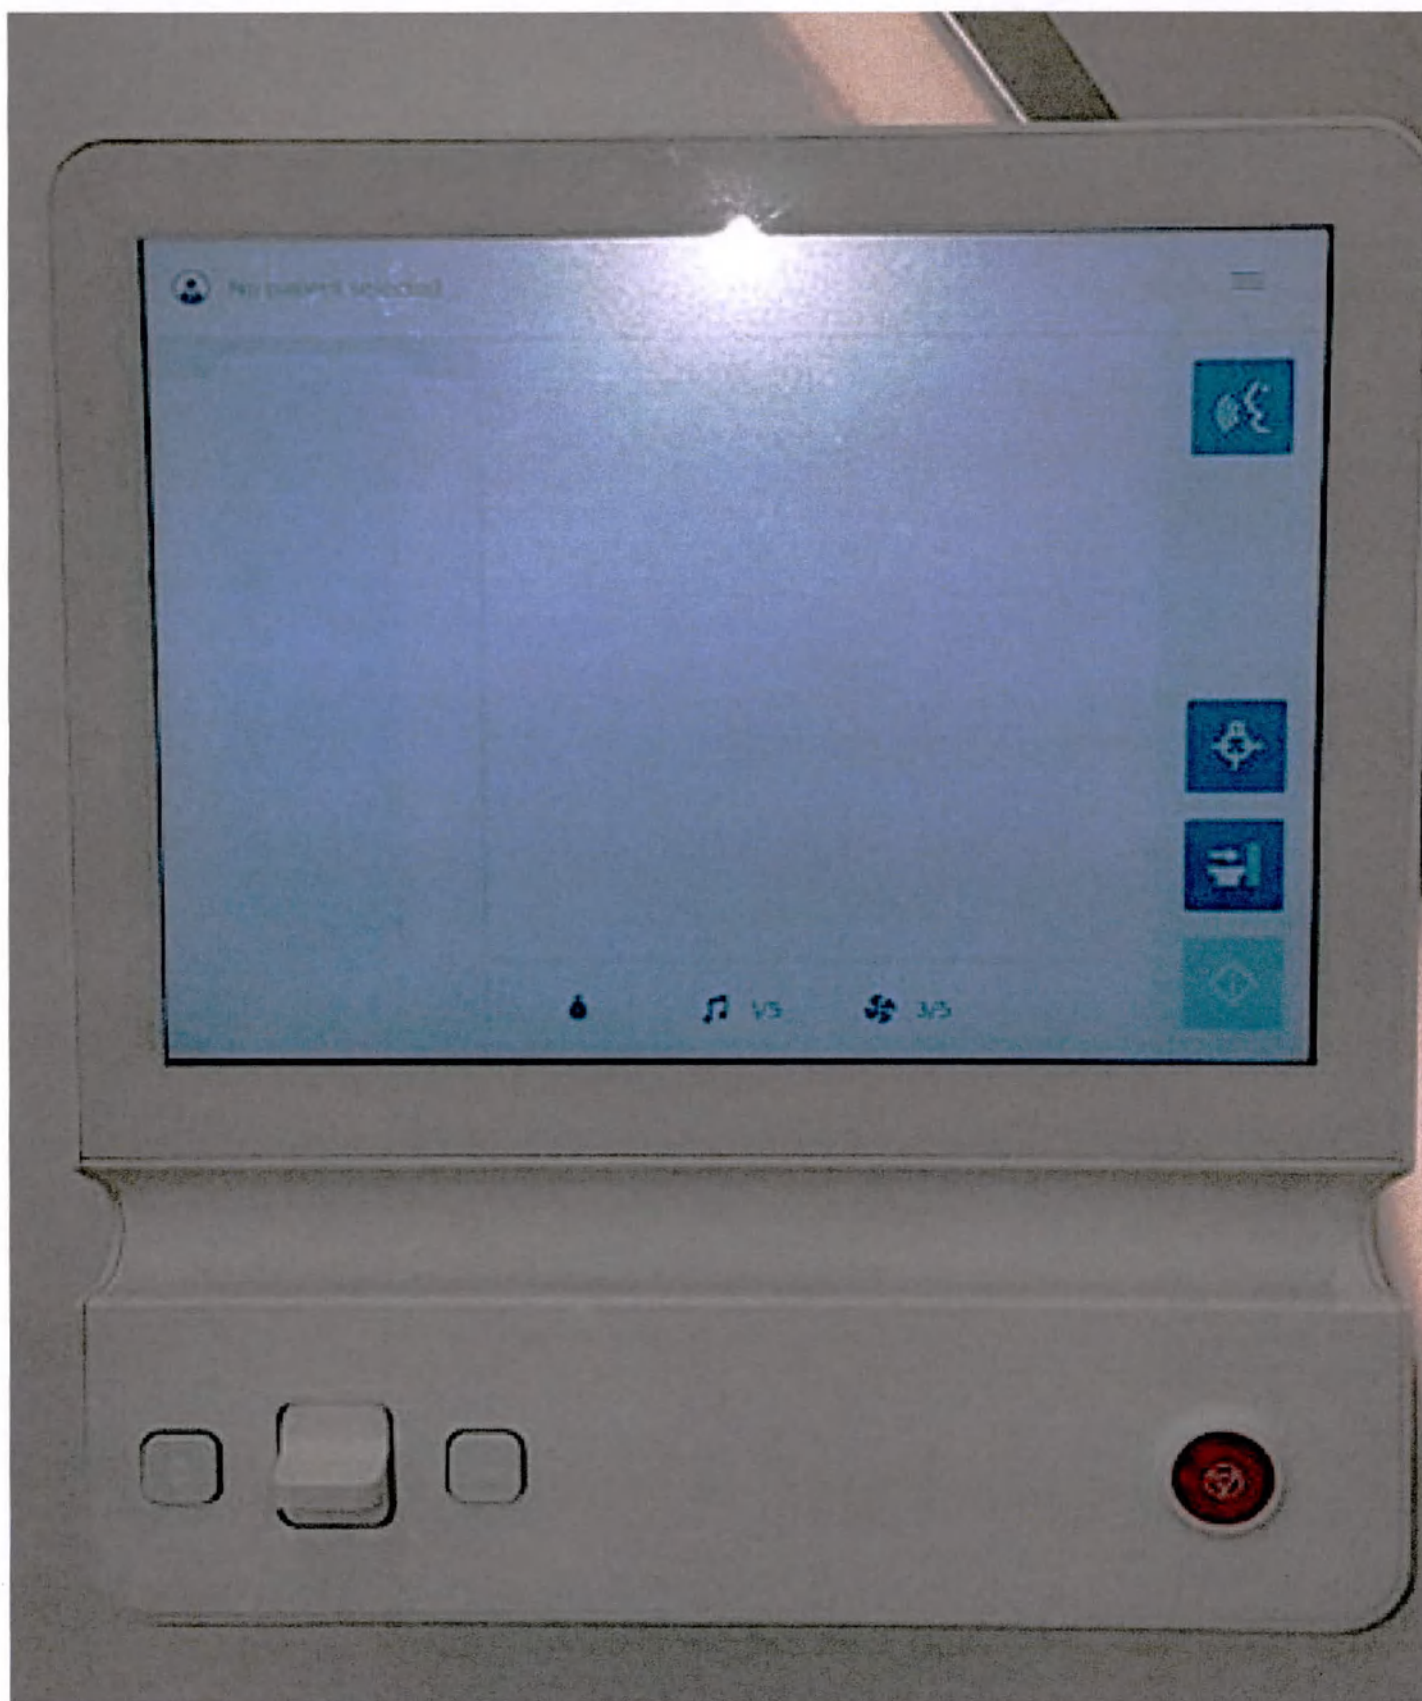


7. Устройство управления VitalScreen.

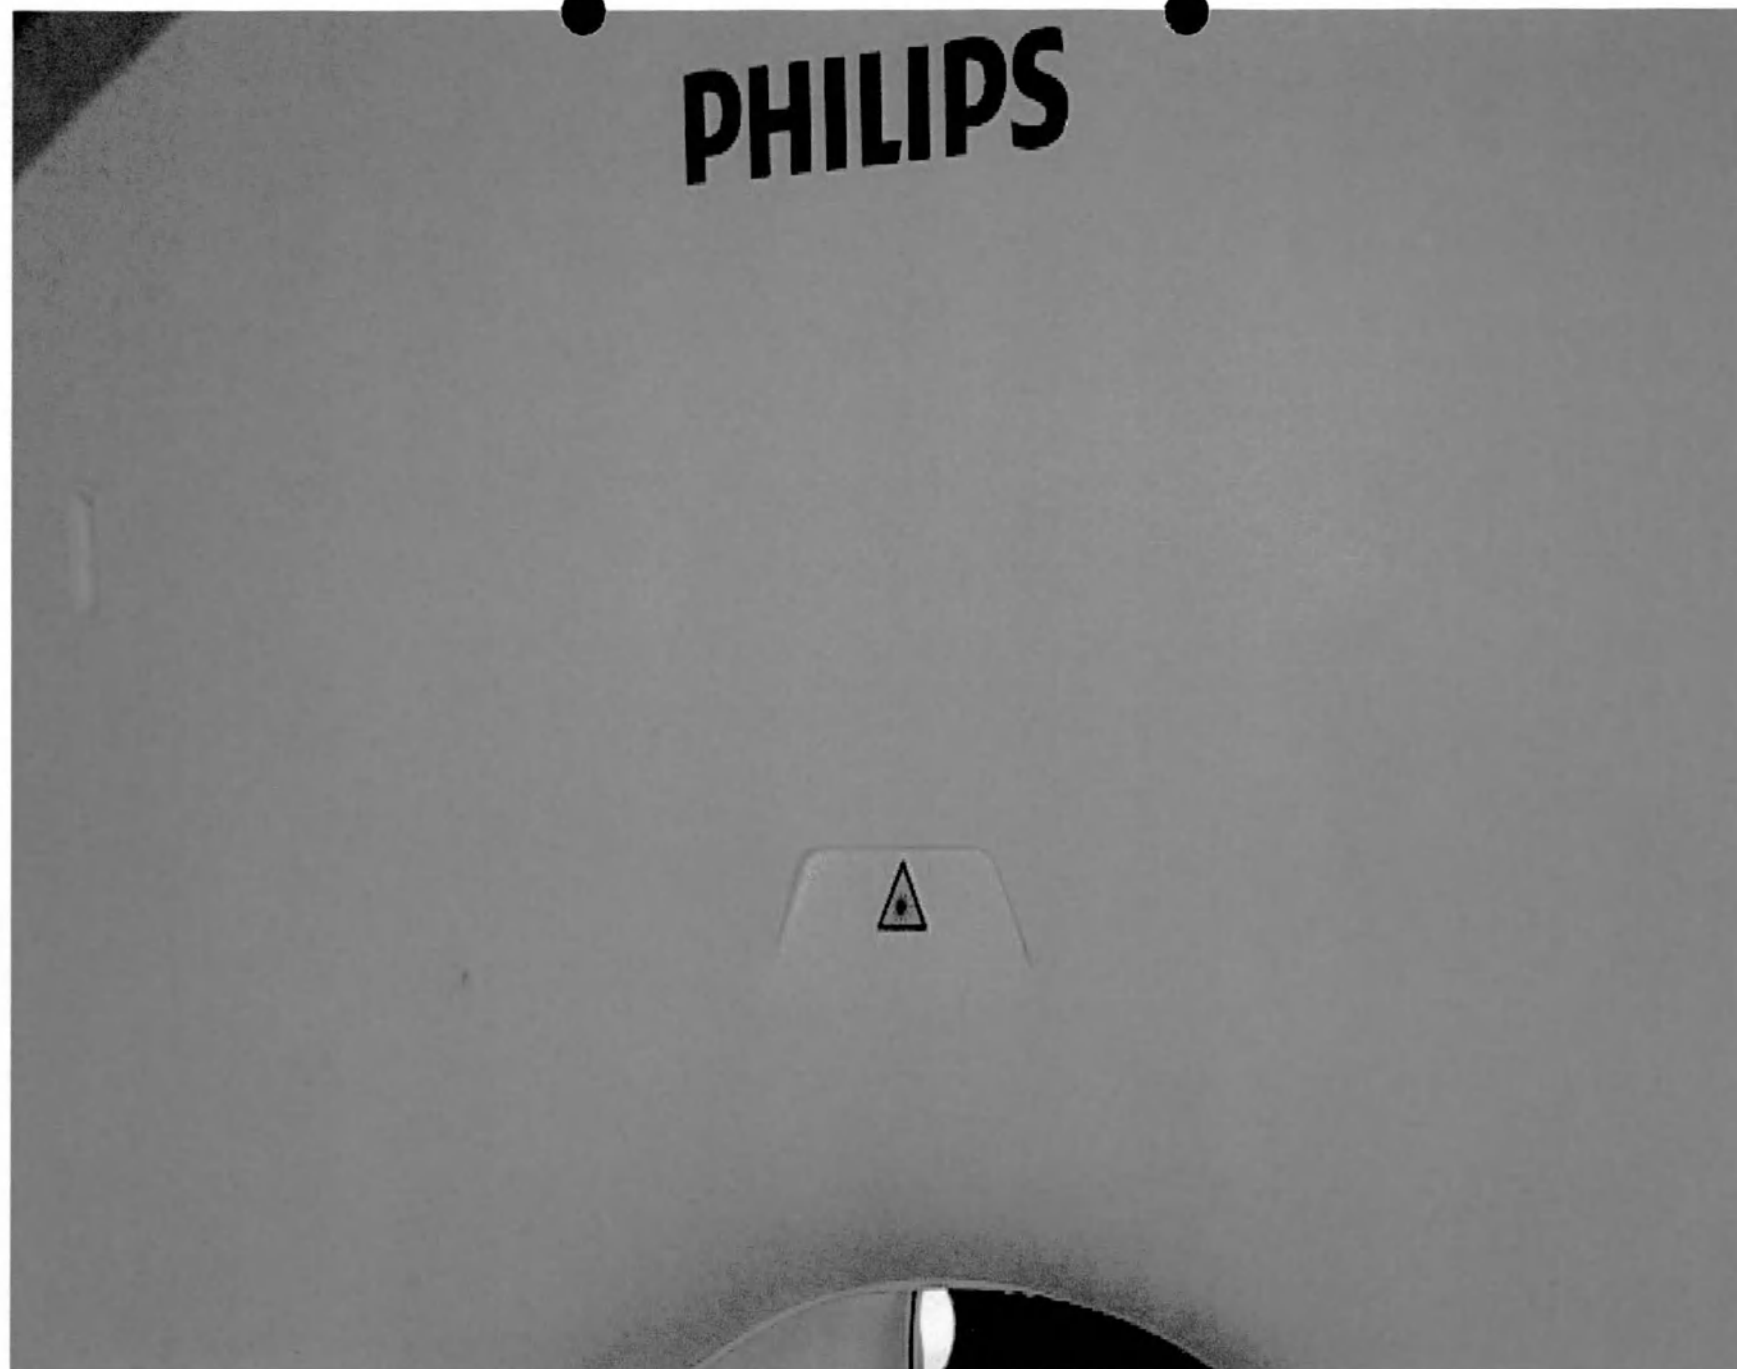


8. Лазерное устройство светового визирования (на коже).



8. Лазерное устройство светового визирования (вблизи).

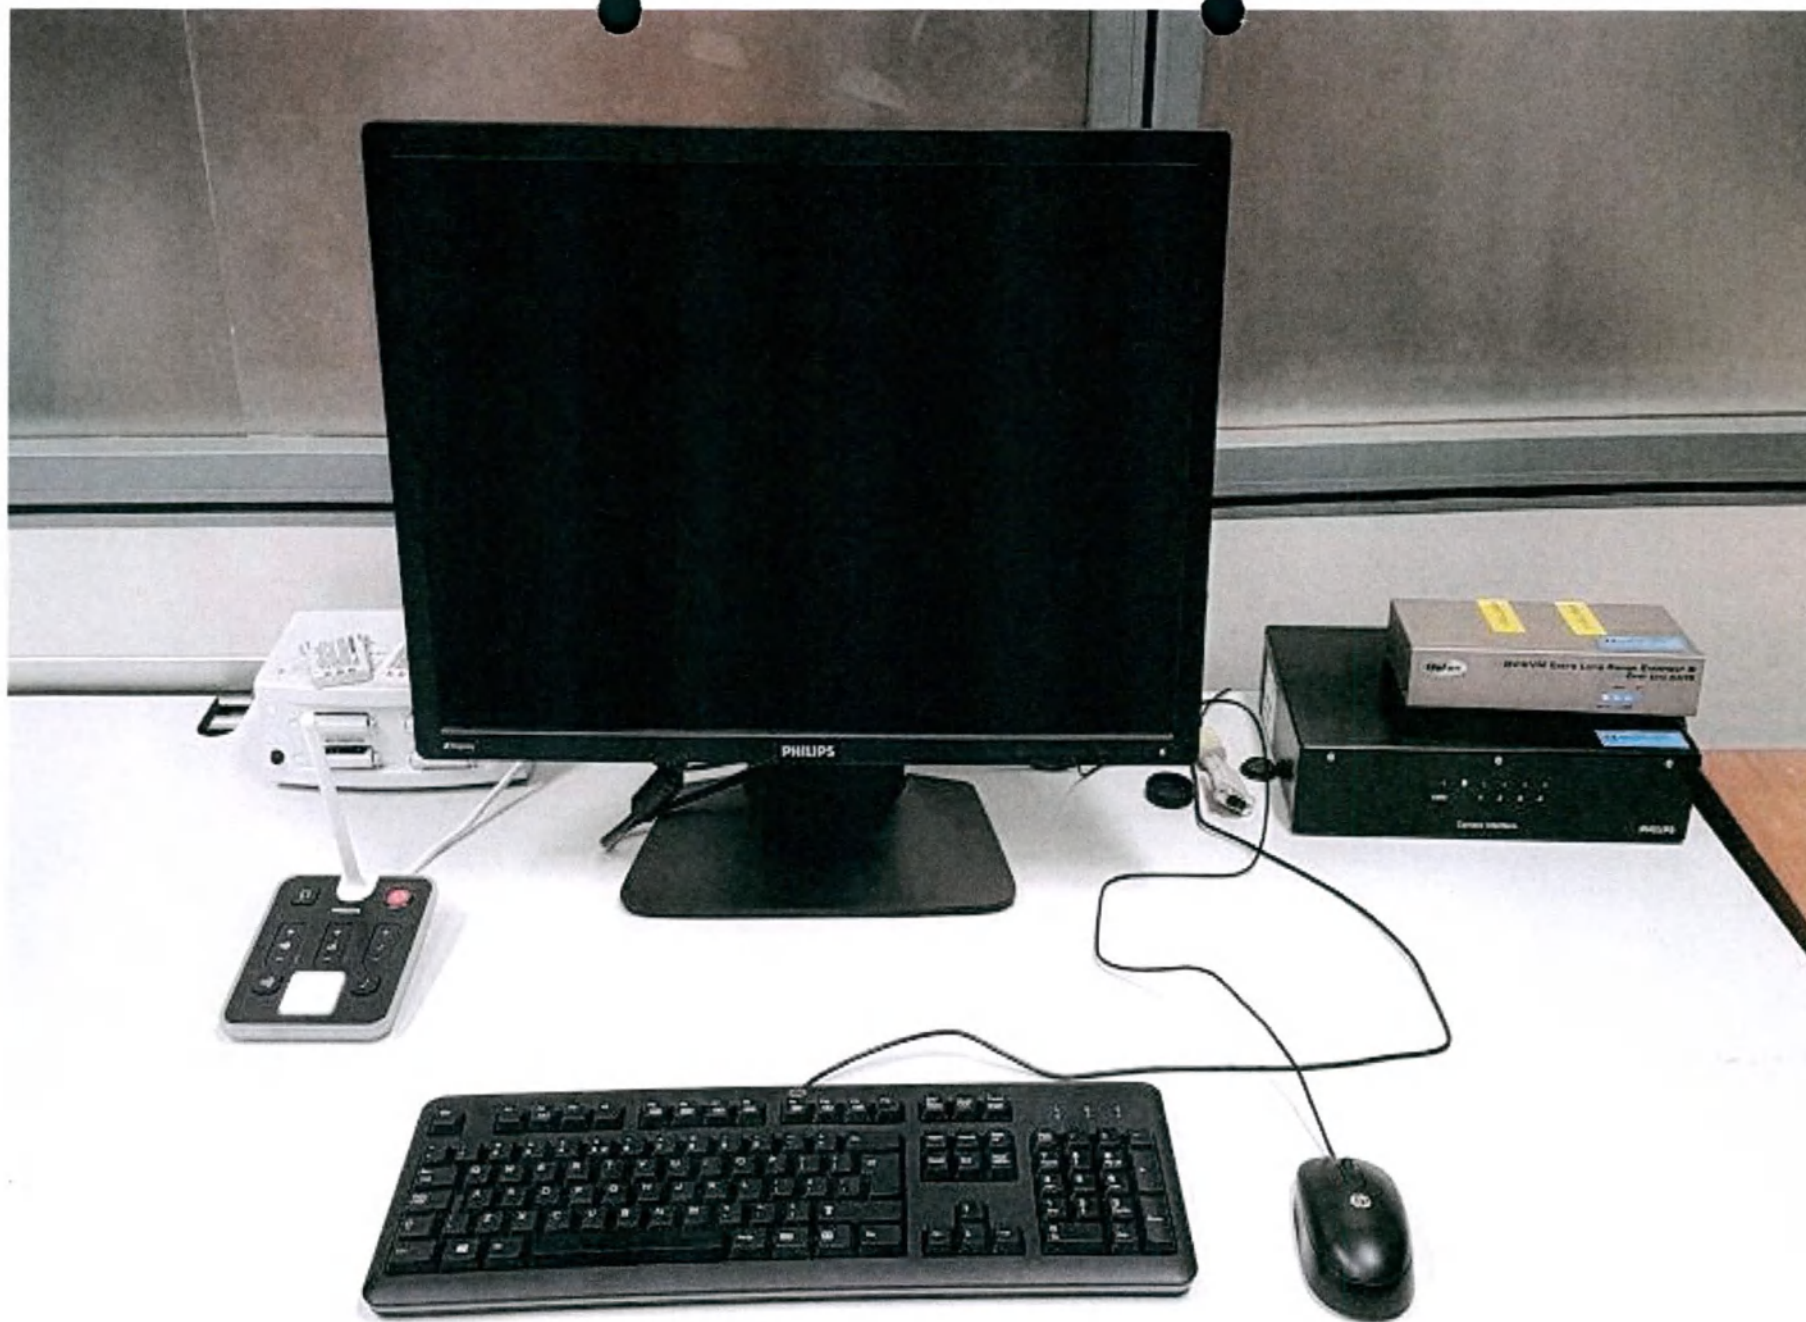


9. Пульт оператора.

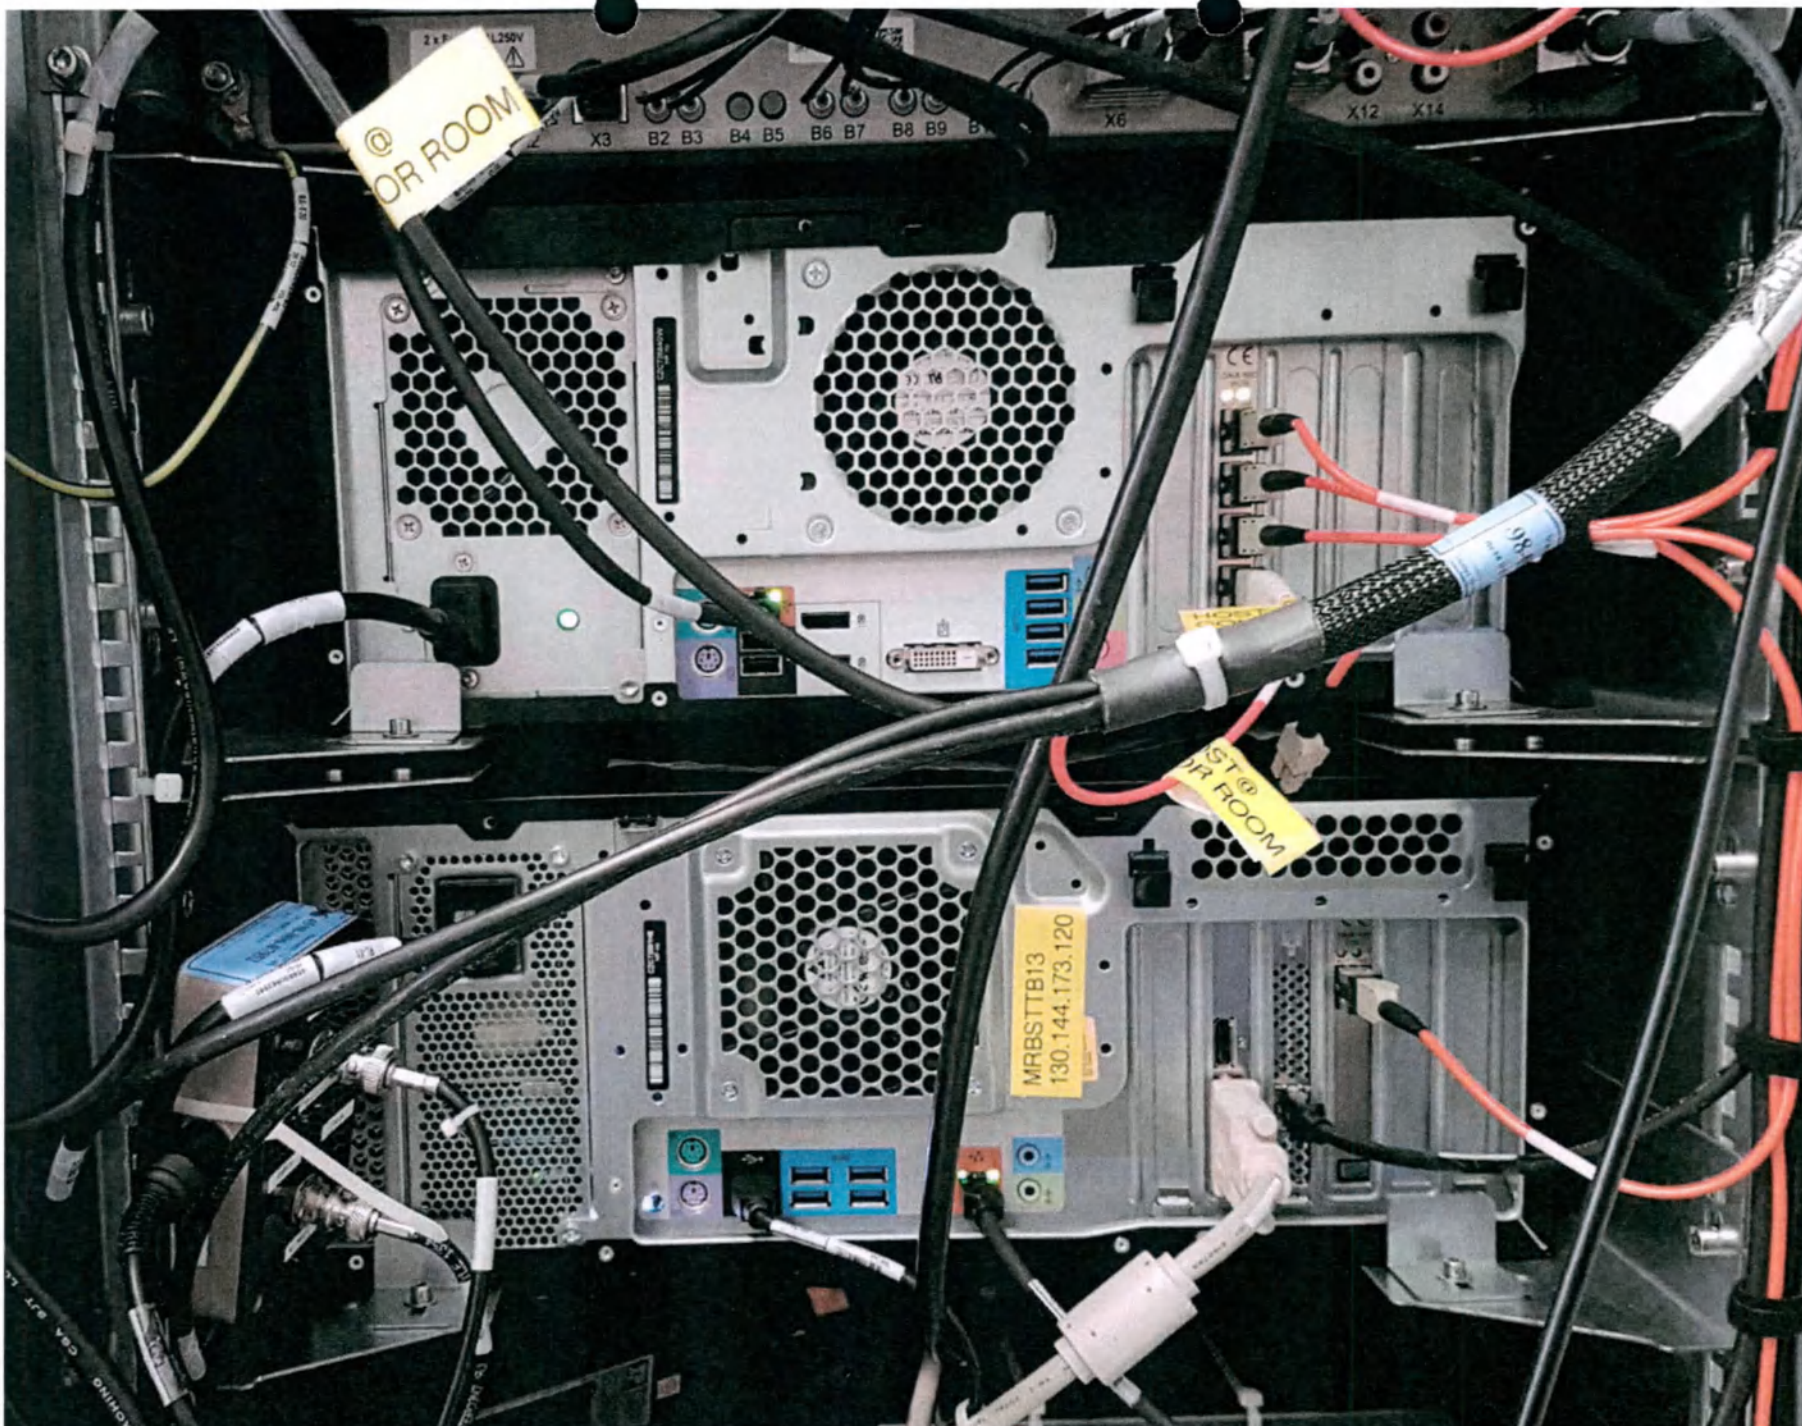

9.1. Компьютерная система (системный блок с оперативной системой Windows и ПО МР-системы версии R 11.1 и выше на электронных и/или виртуальных носителях).




9.2. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа, на оптических и/или электронных и/или на виртуальных носителях, в составе.

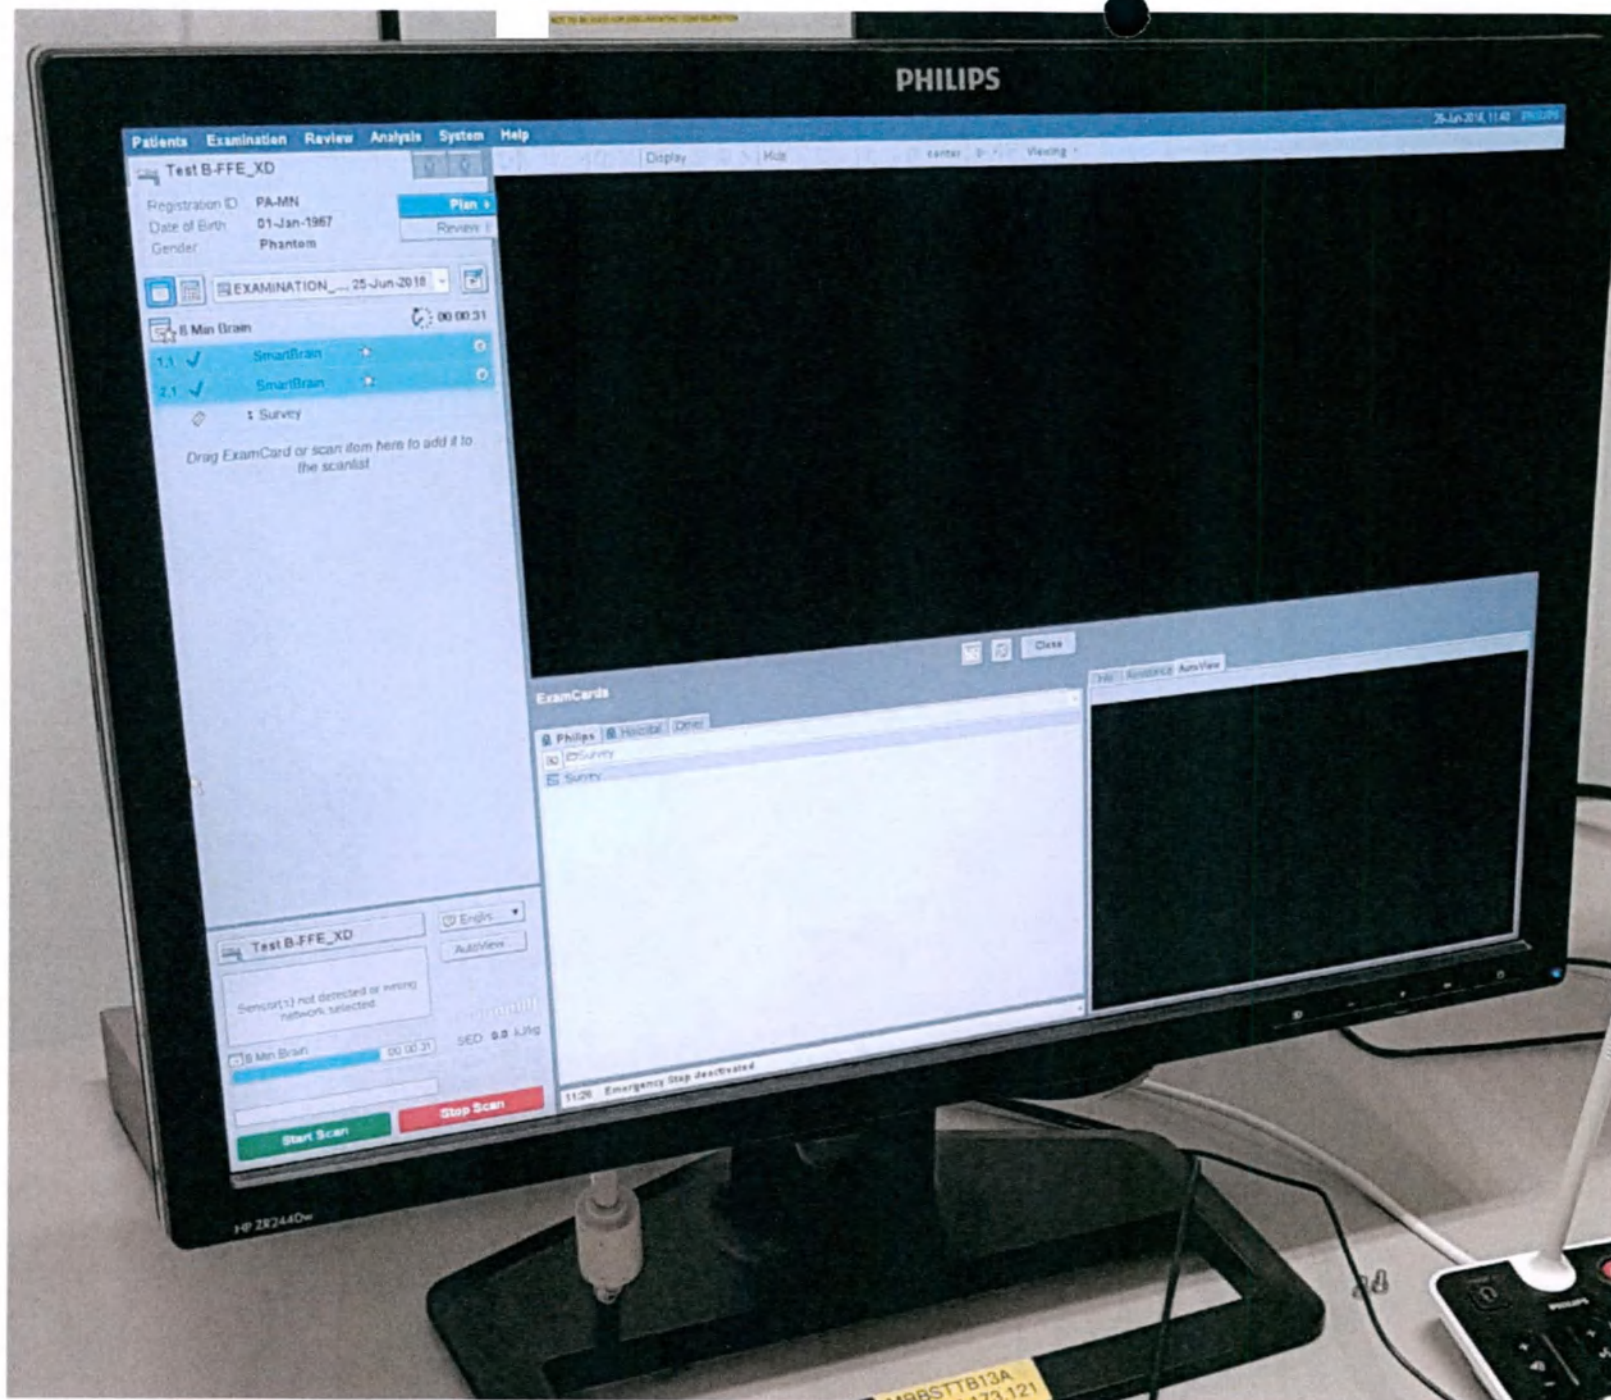


9.2. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа, на оптических и/или электронных и/или на виртуальных носителях – не более 100 шт., в составе. (Начальная страница программных обеспечений на дисплее компьютера).




9.3. Внешнее устройство записи DVD.

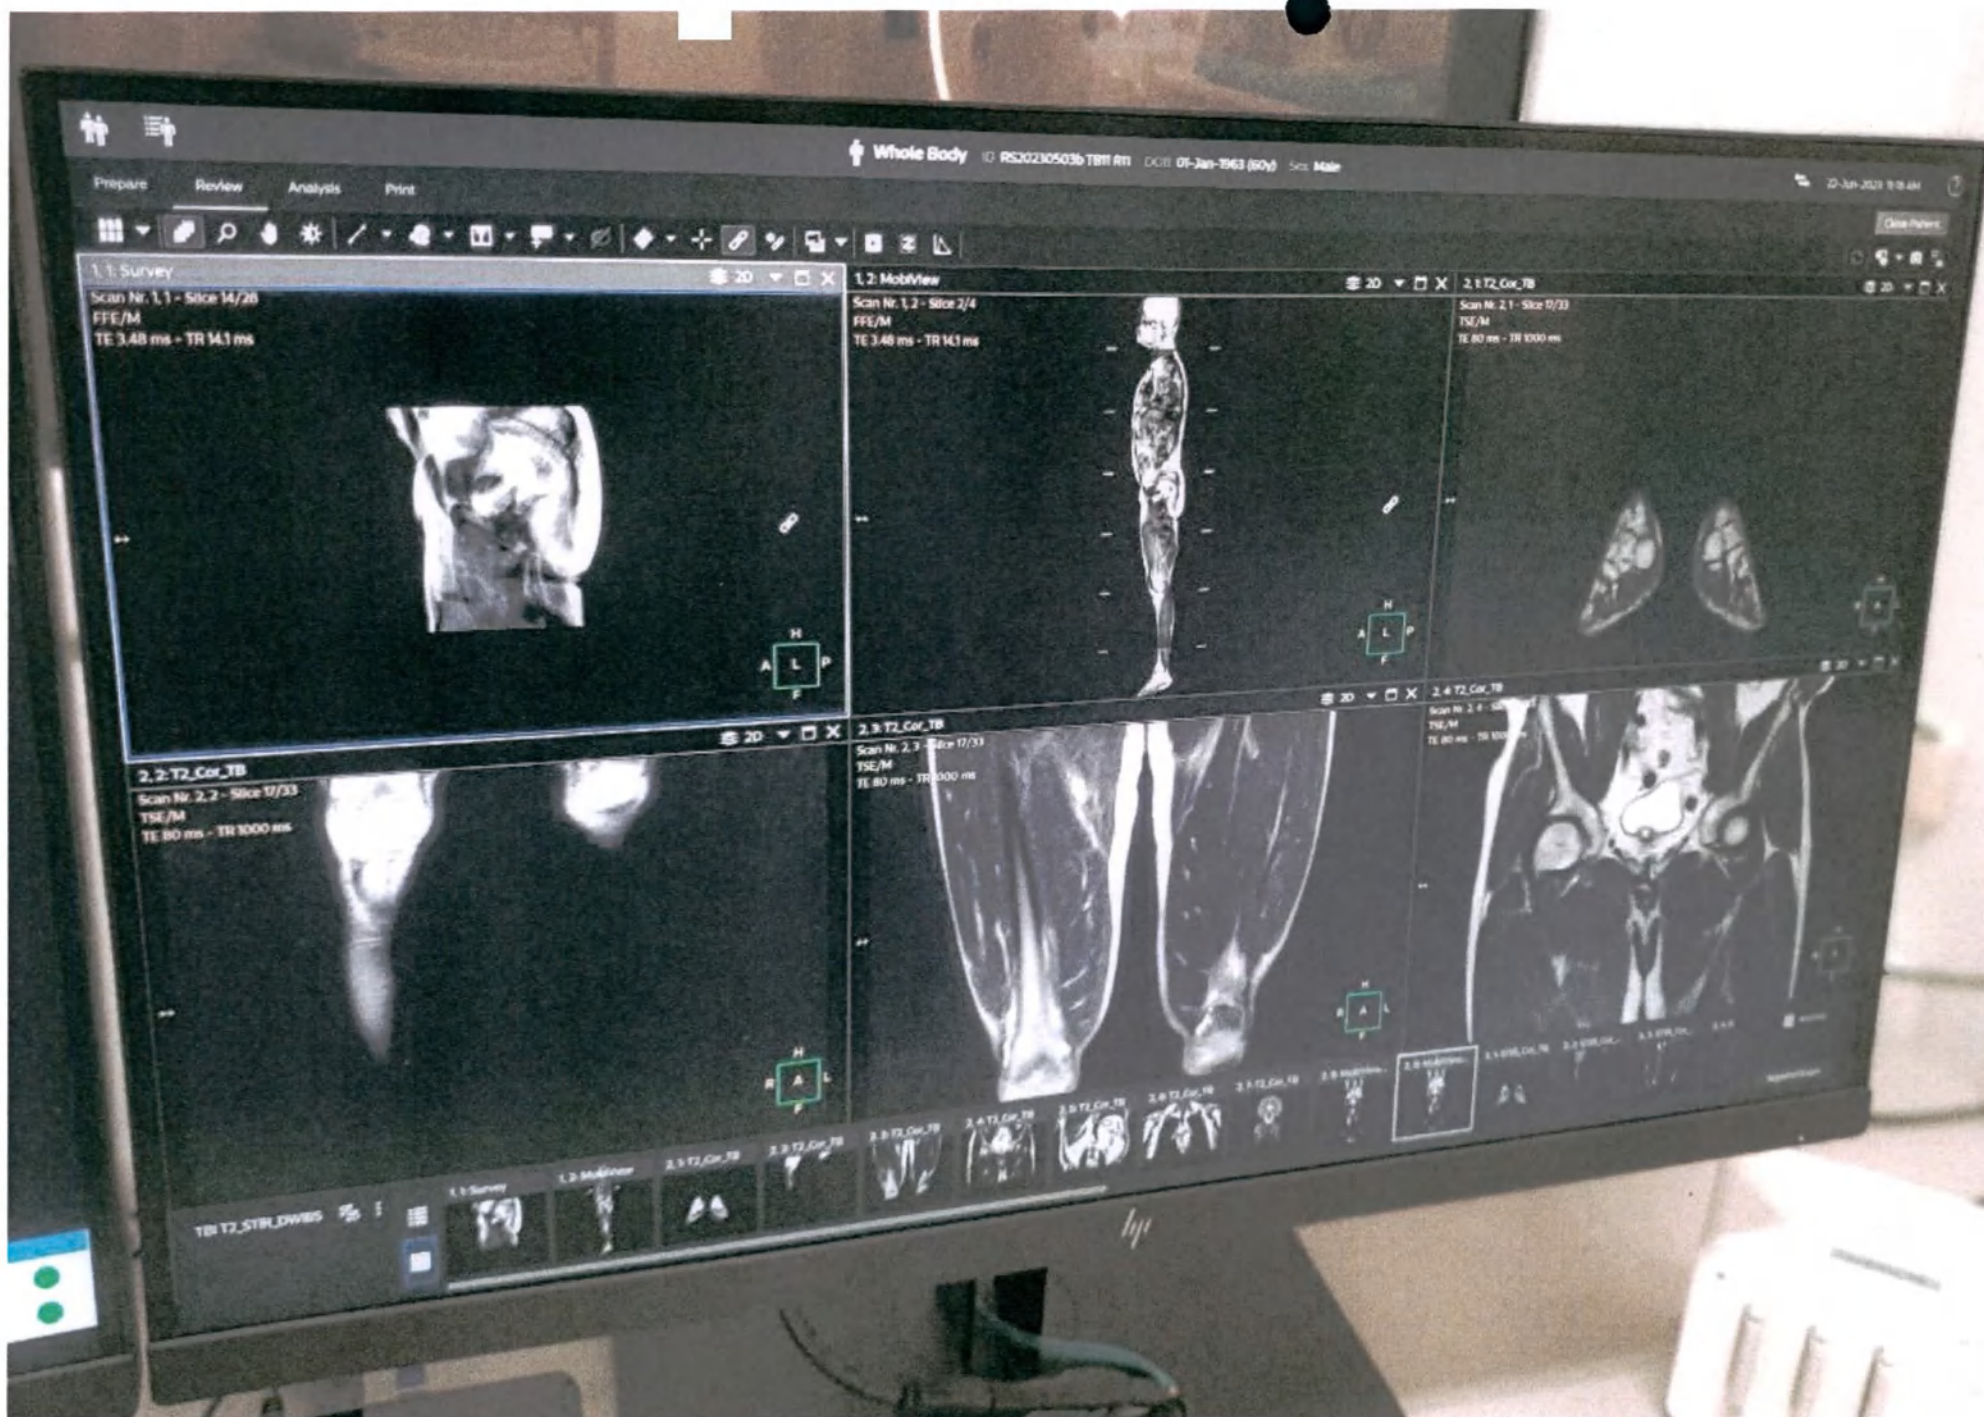


9.4. Широкоэкранный дисплей с USB-разъемами.

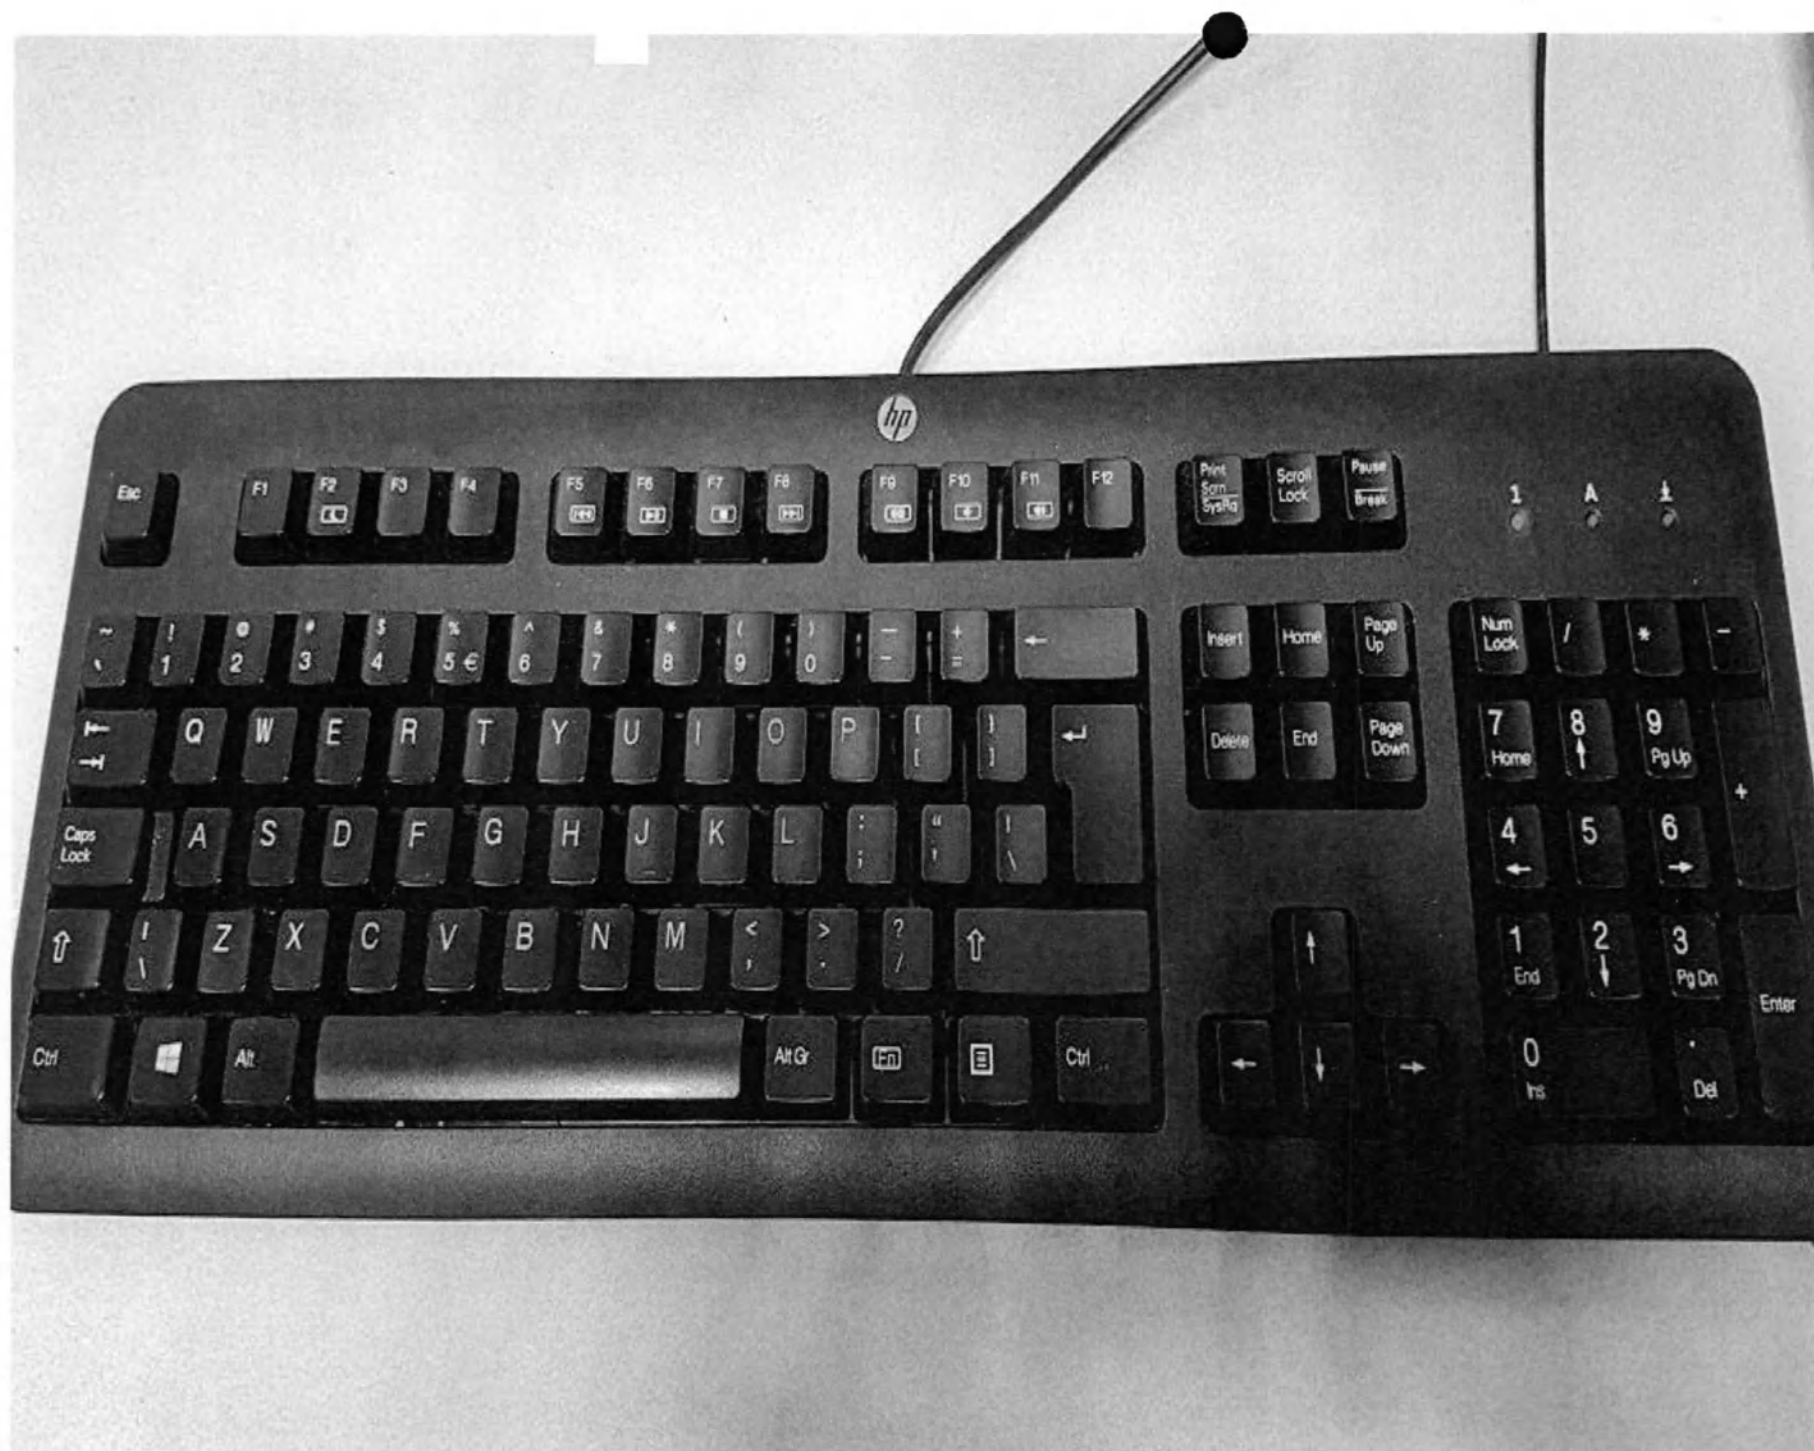


9.5. Клавиатура.

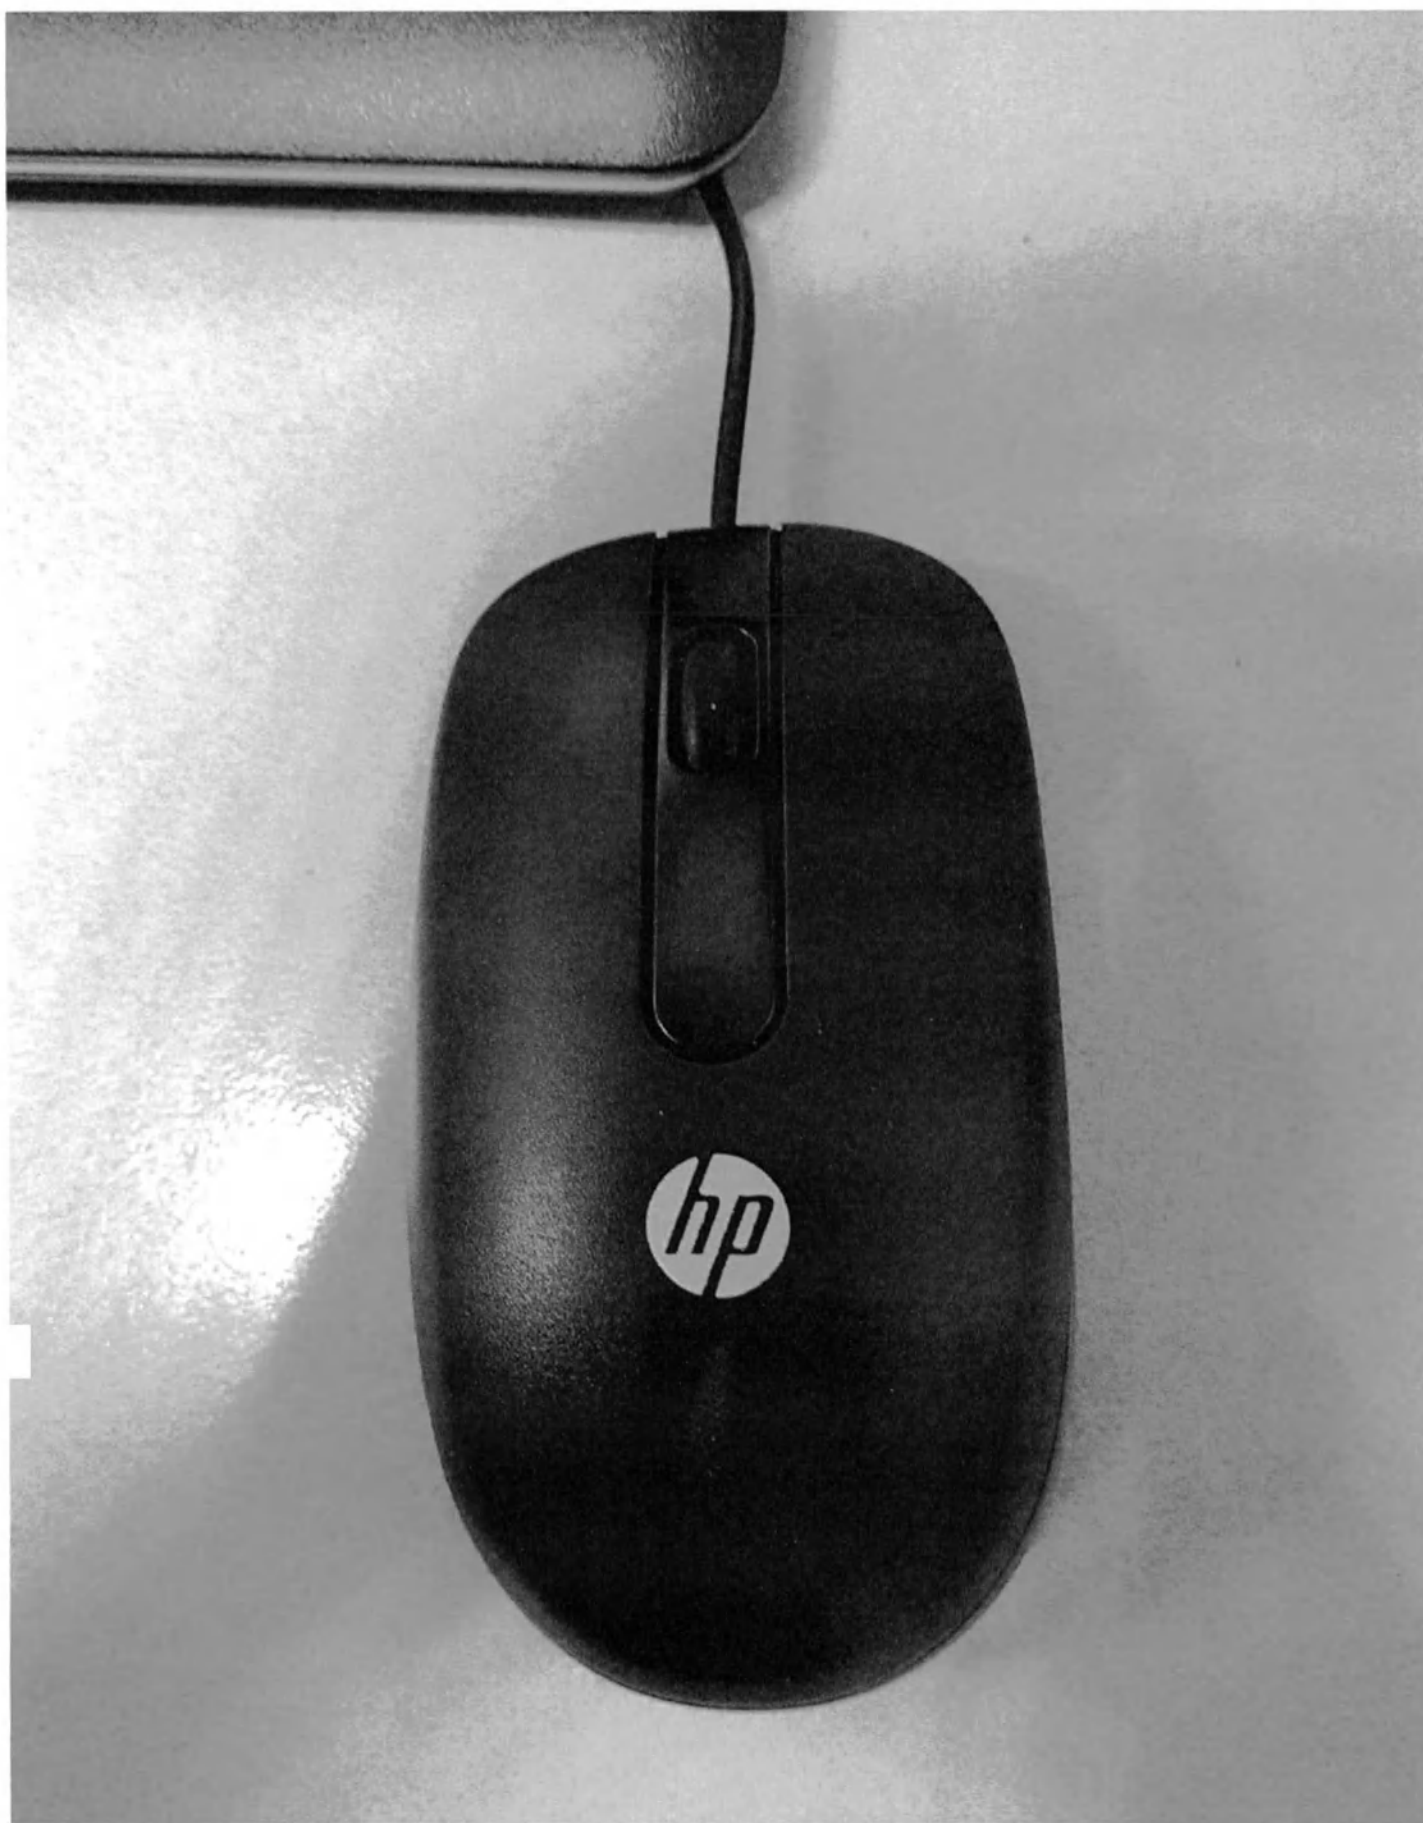


9.6. Мышь.

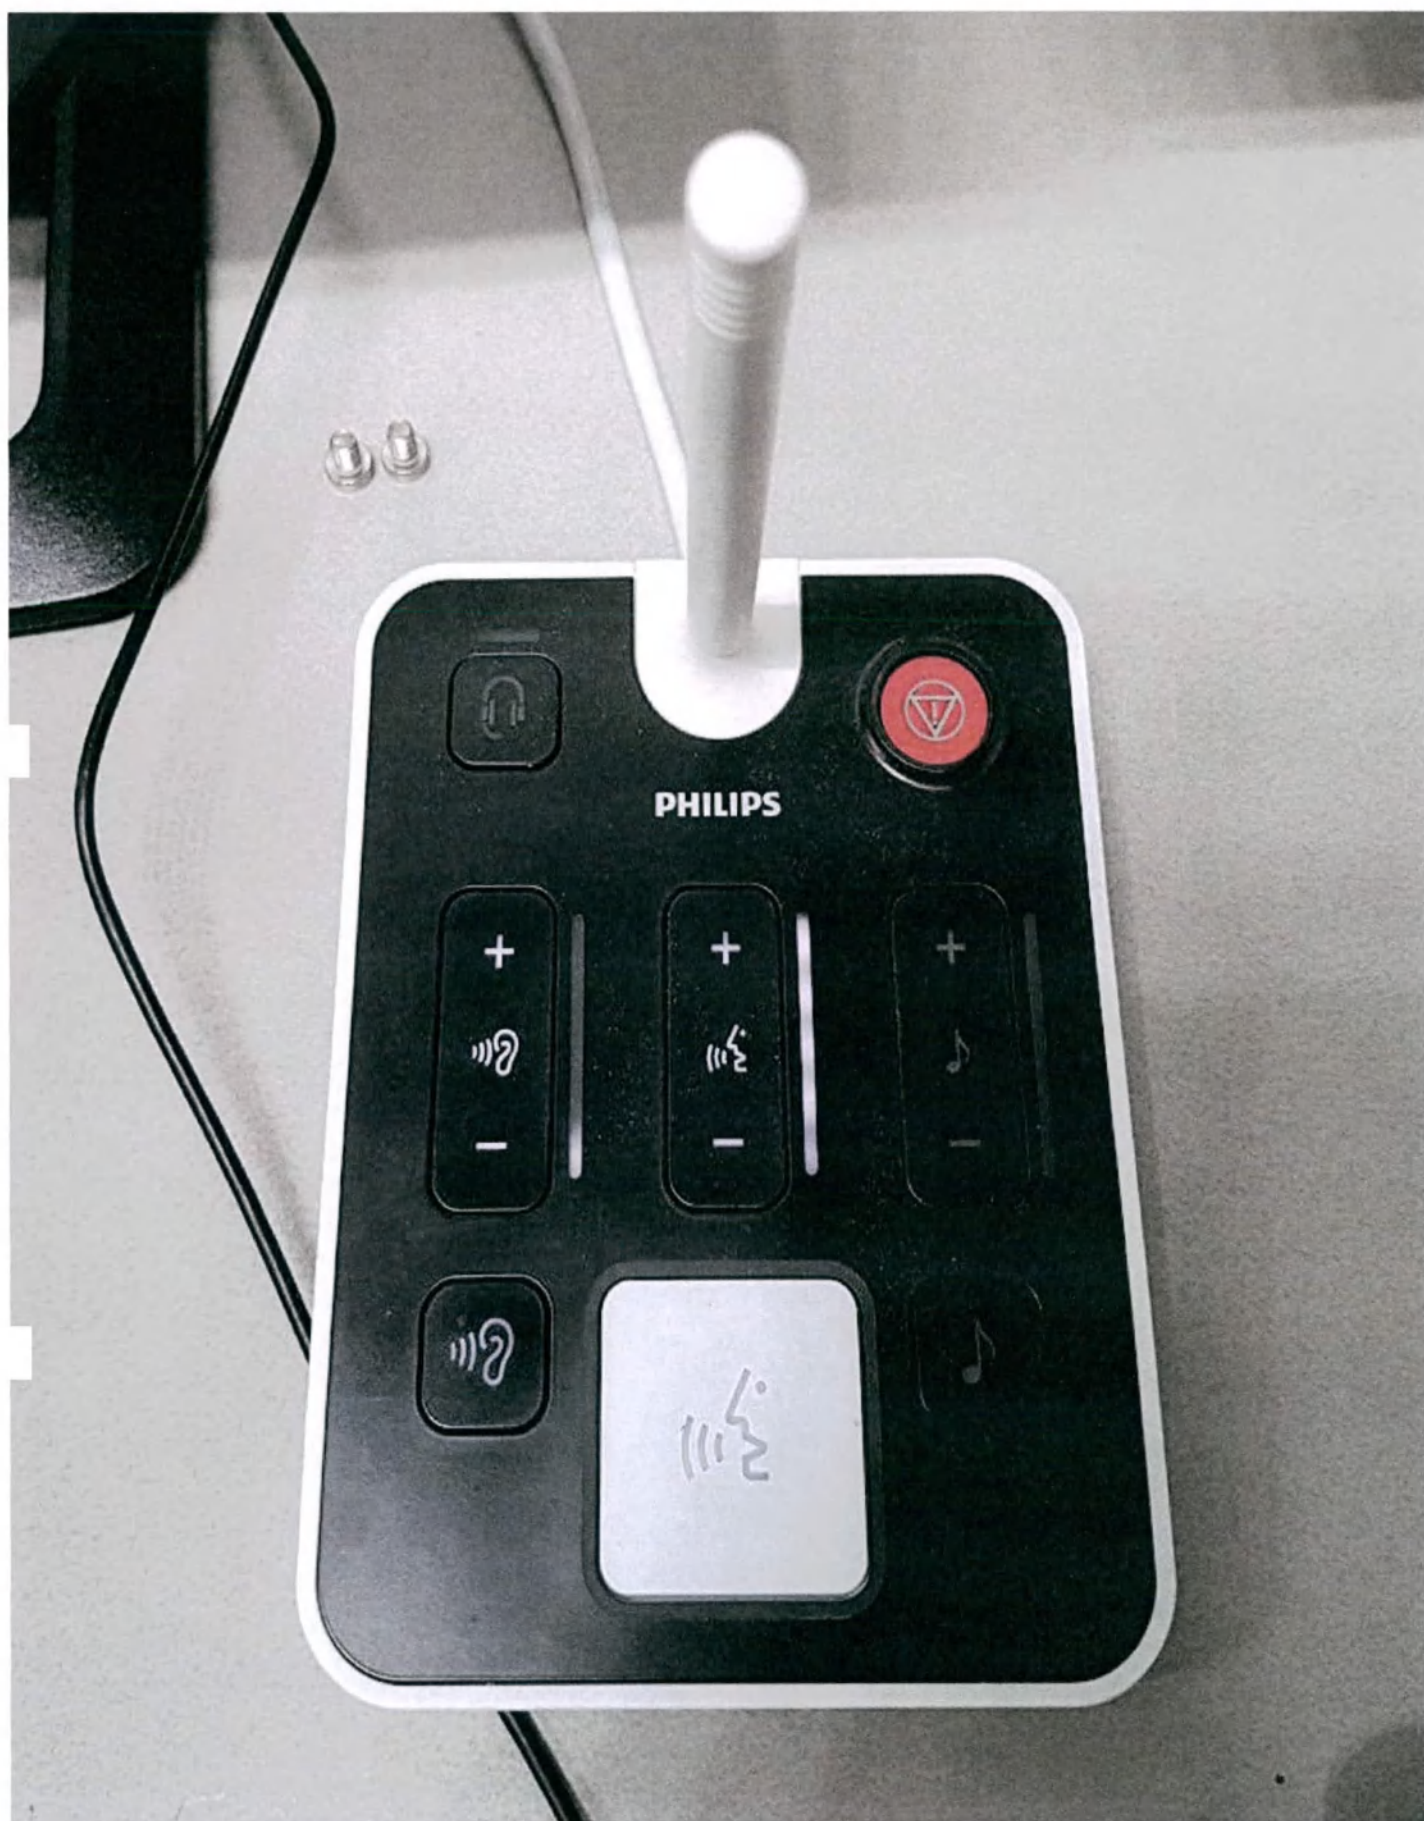


9.7. Система связи «оператор-пациент».

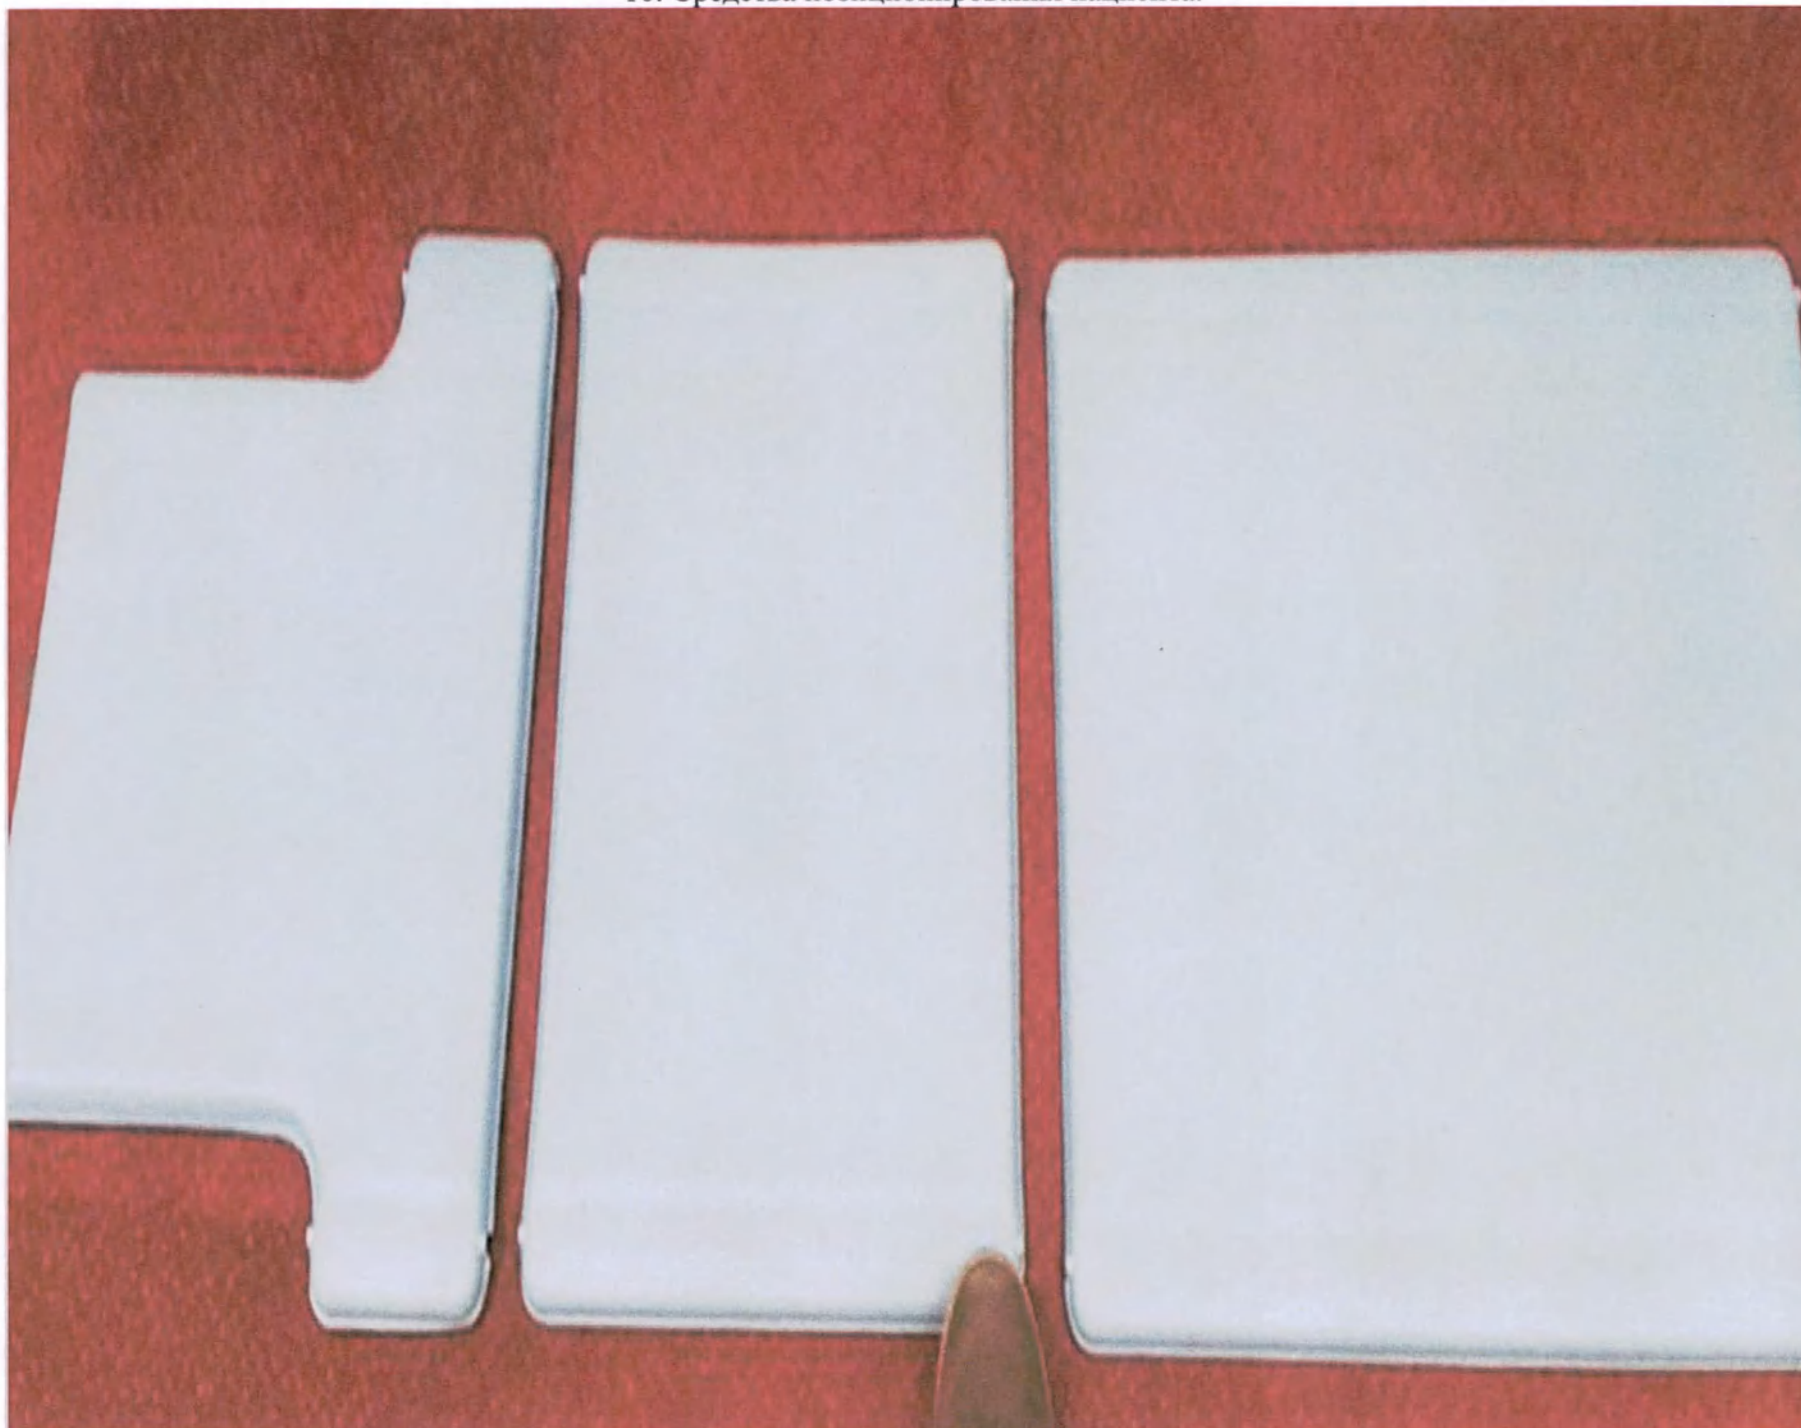

10.1. Медицинский матрас.

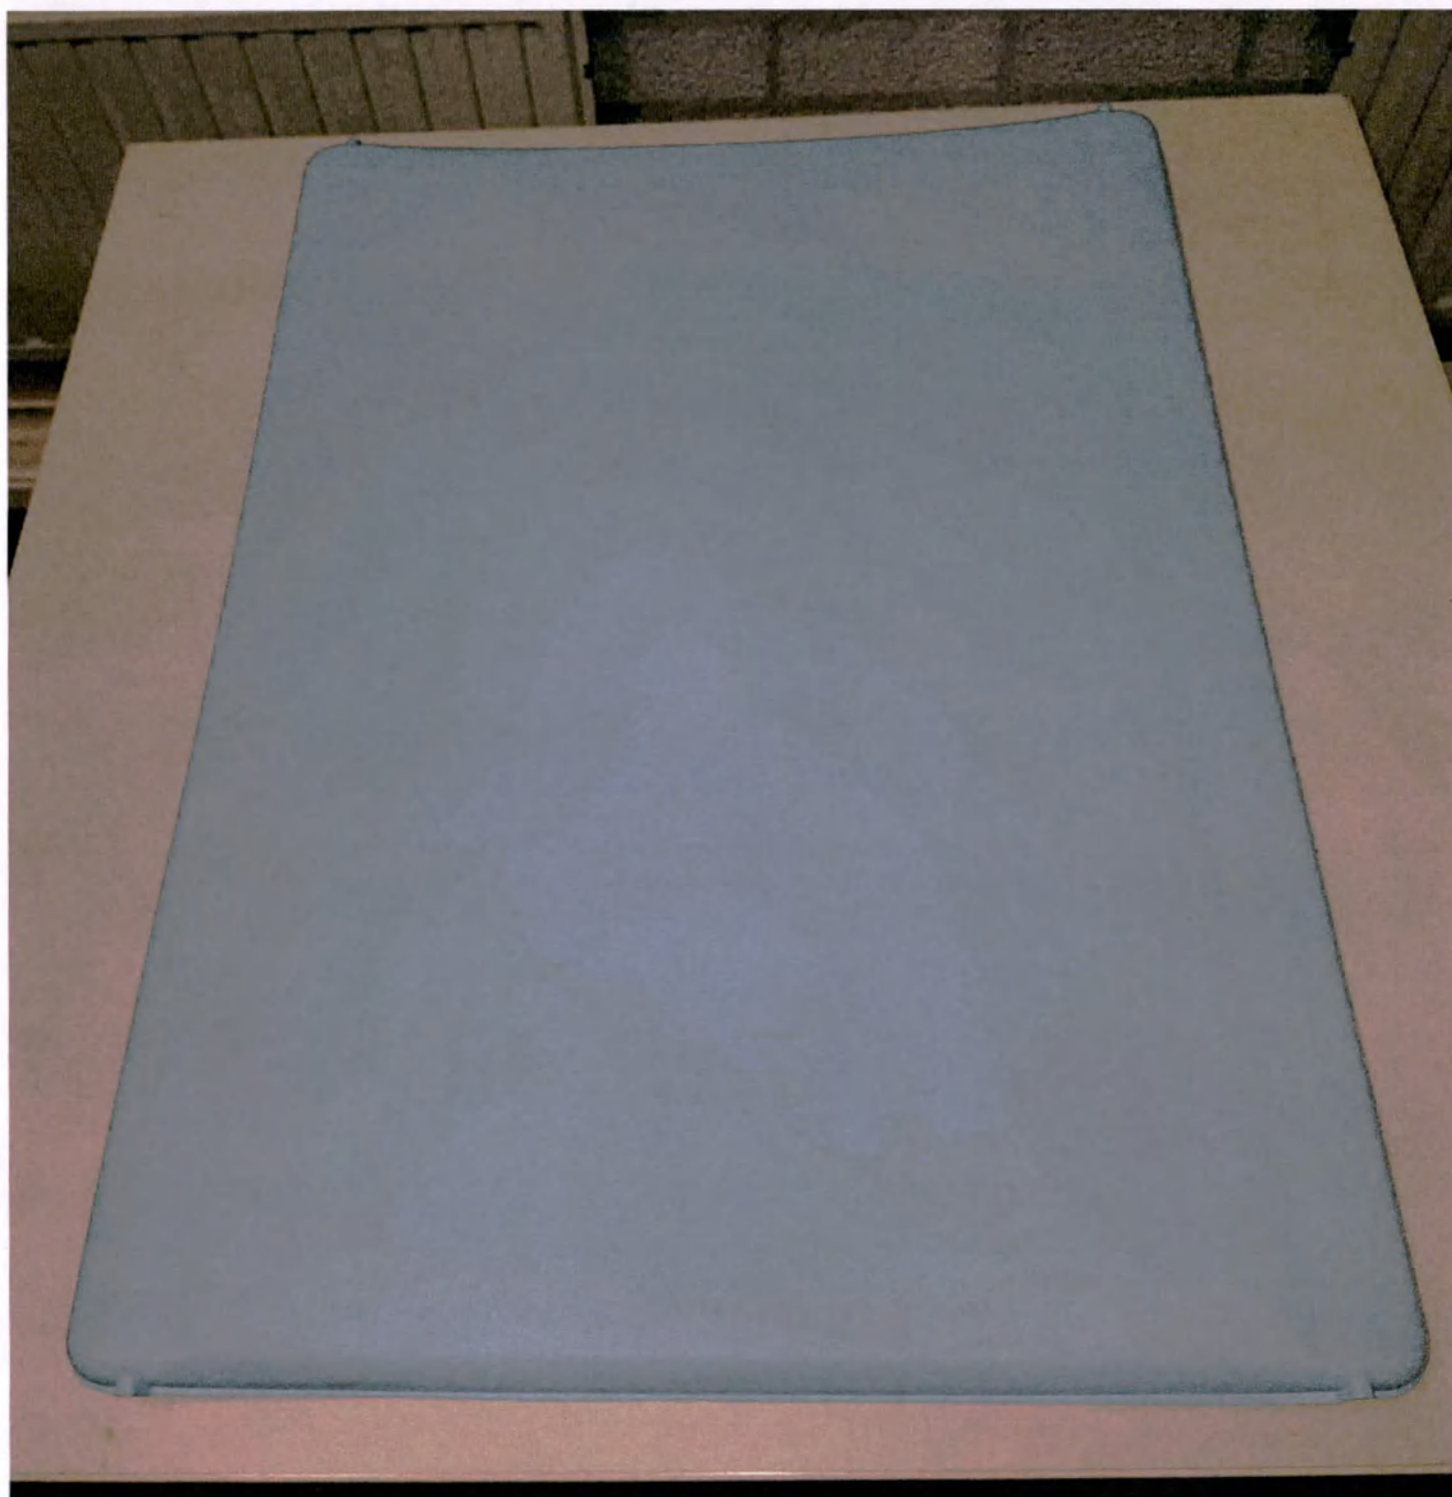


10.1.1 Длинные матрасы (LM).

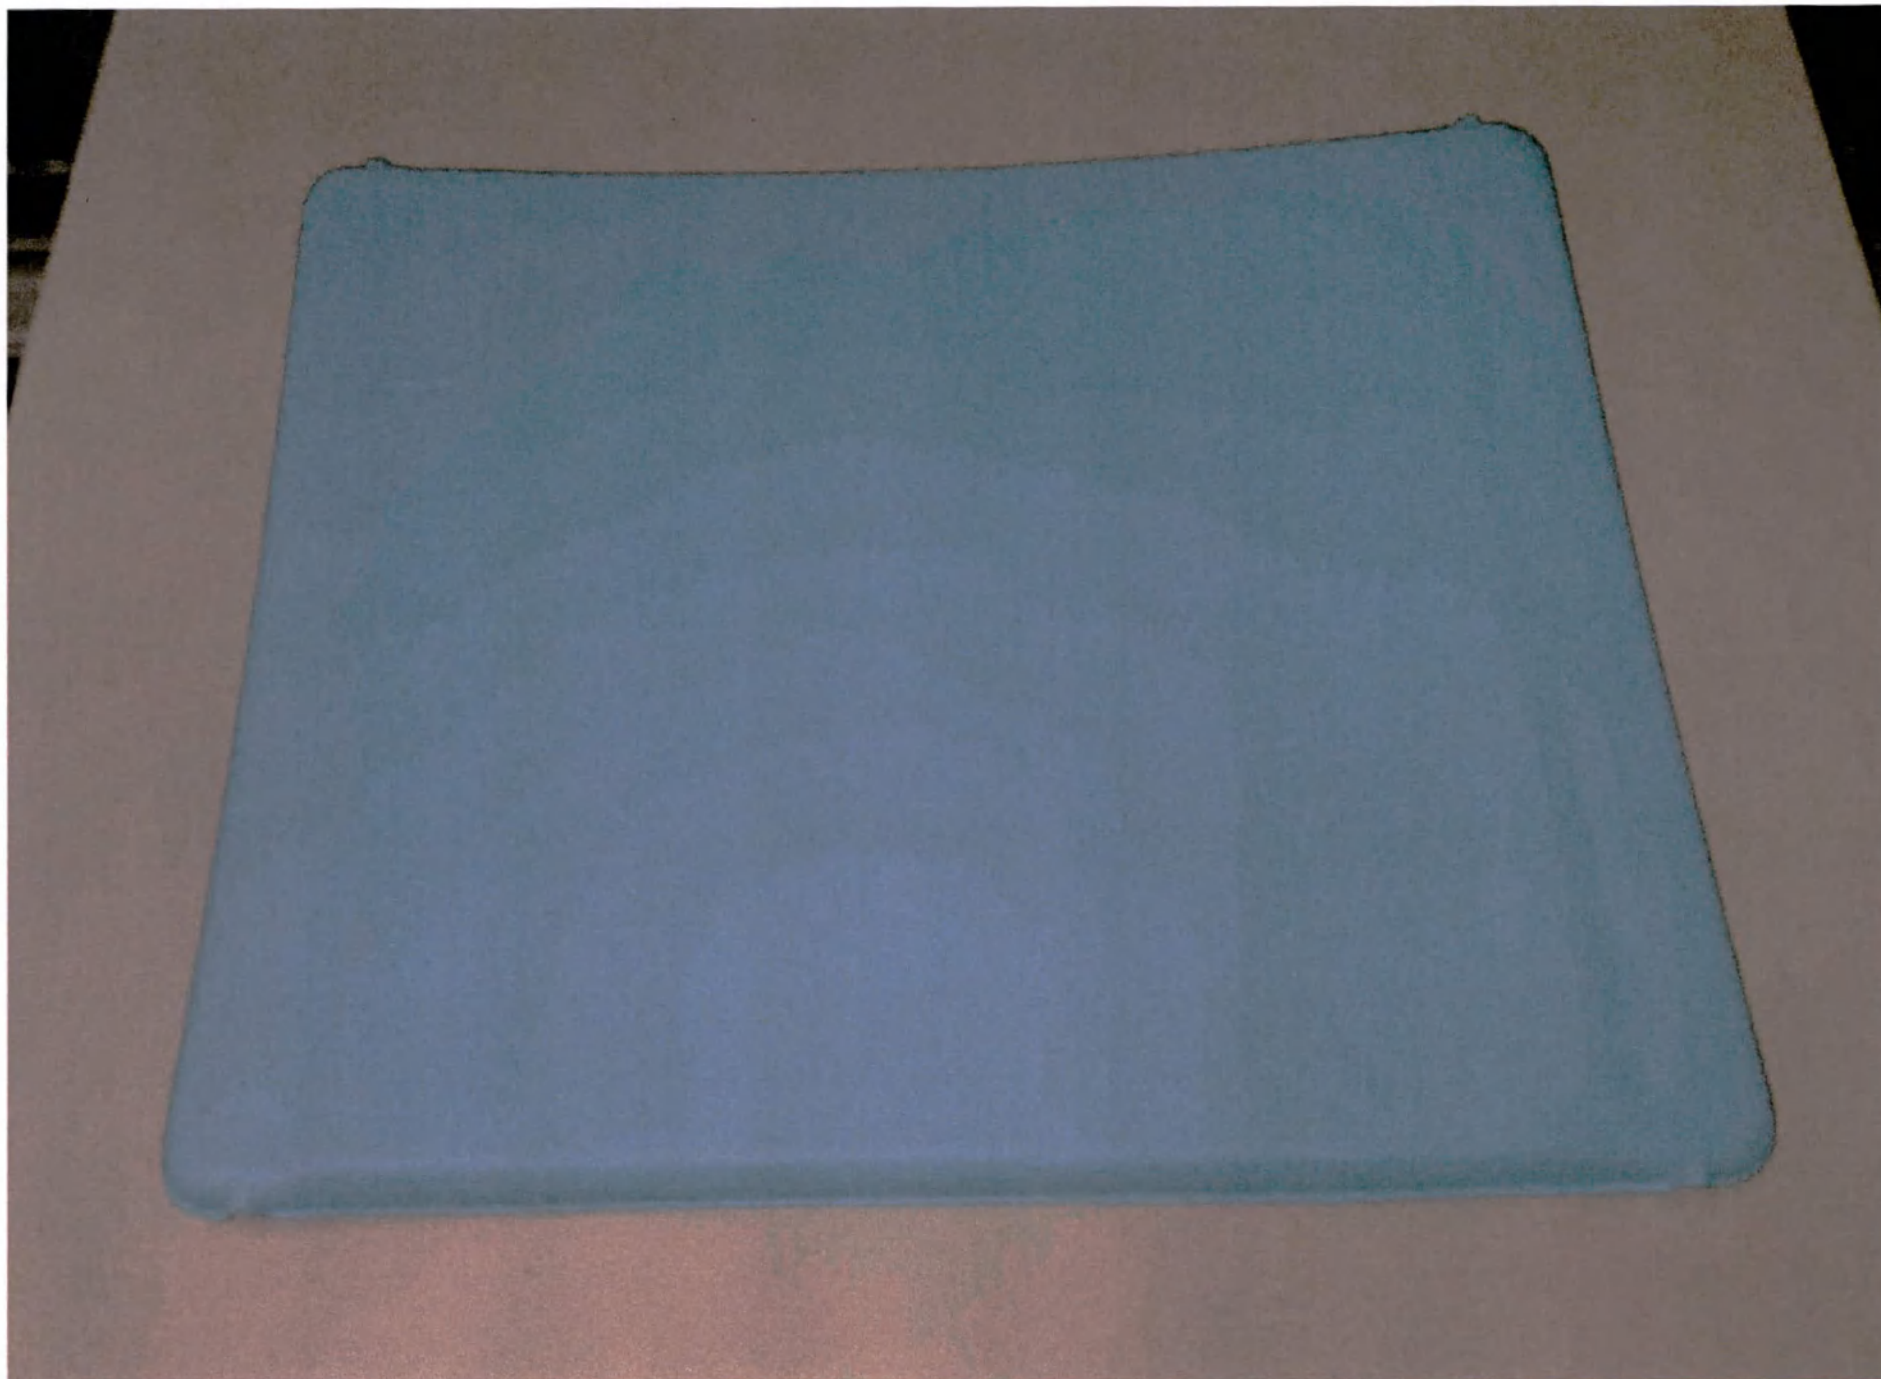


10.1.2 Короткие матрасы (SM).




10.1.3 Т-образный матрас (ТМ).

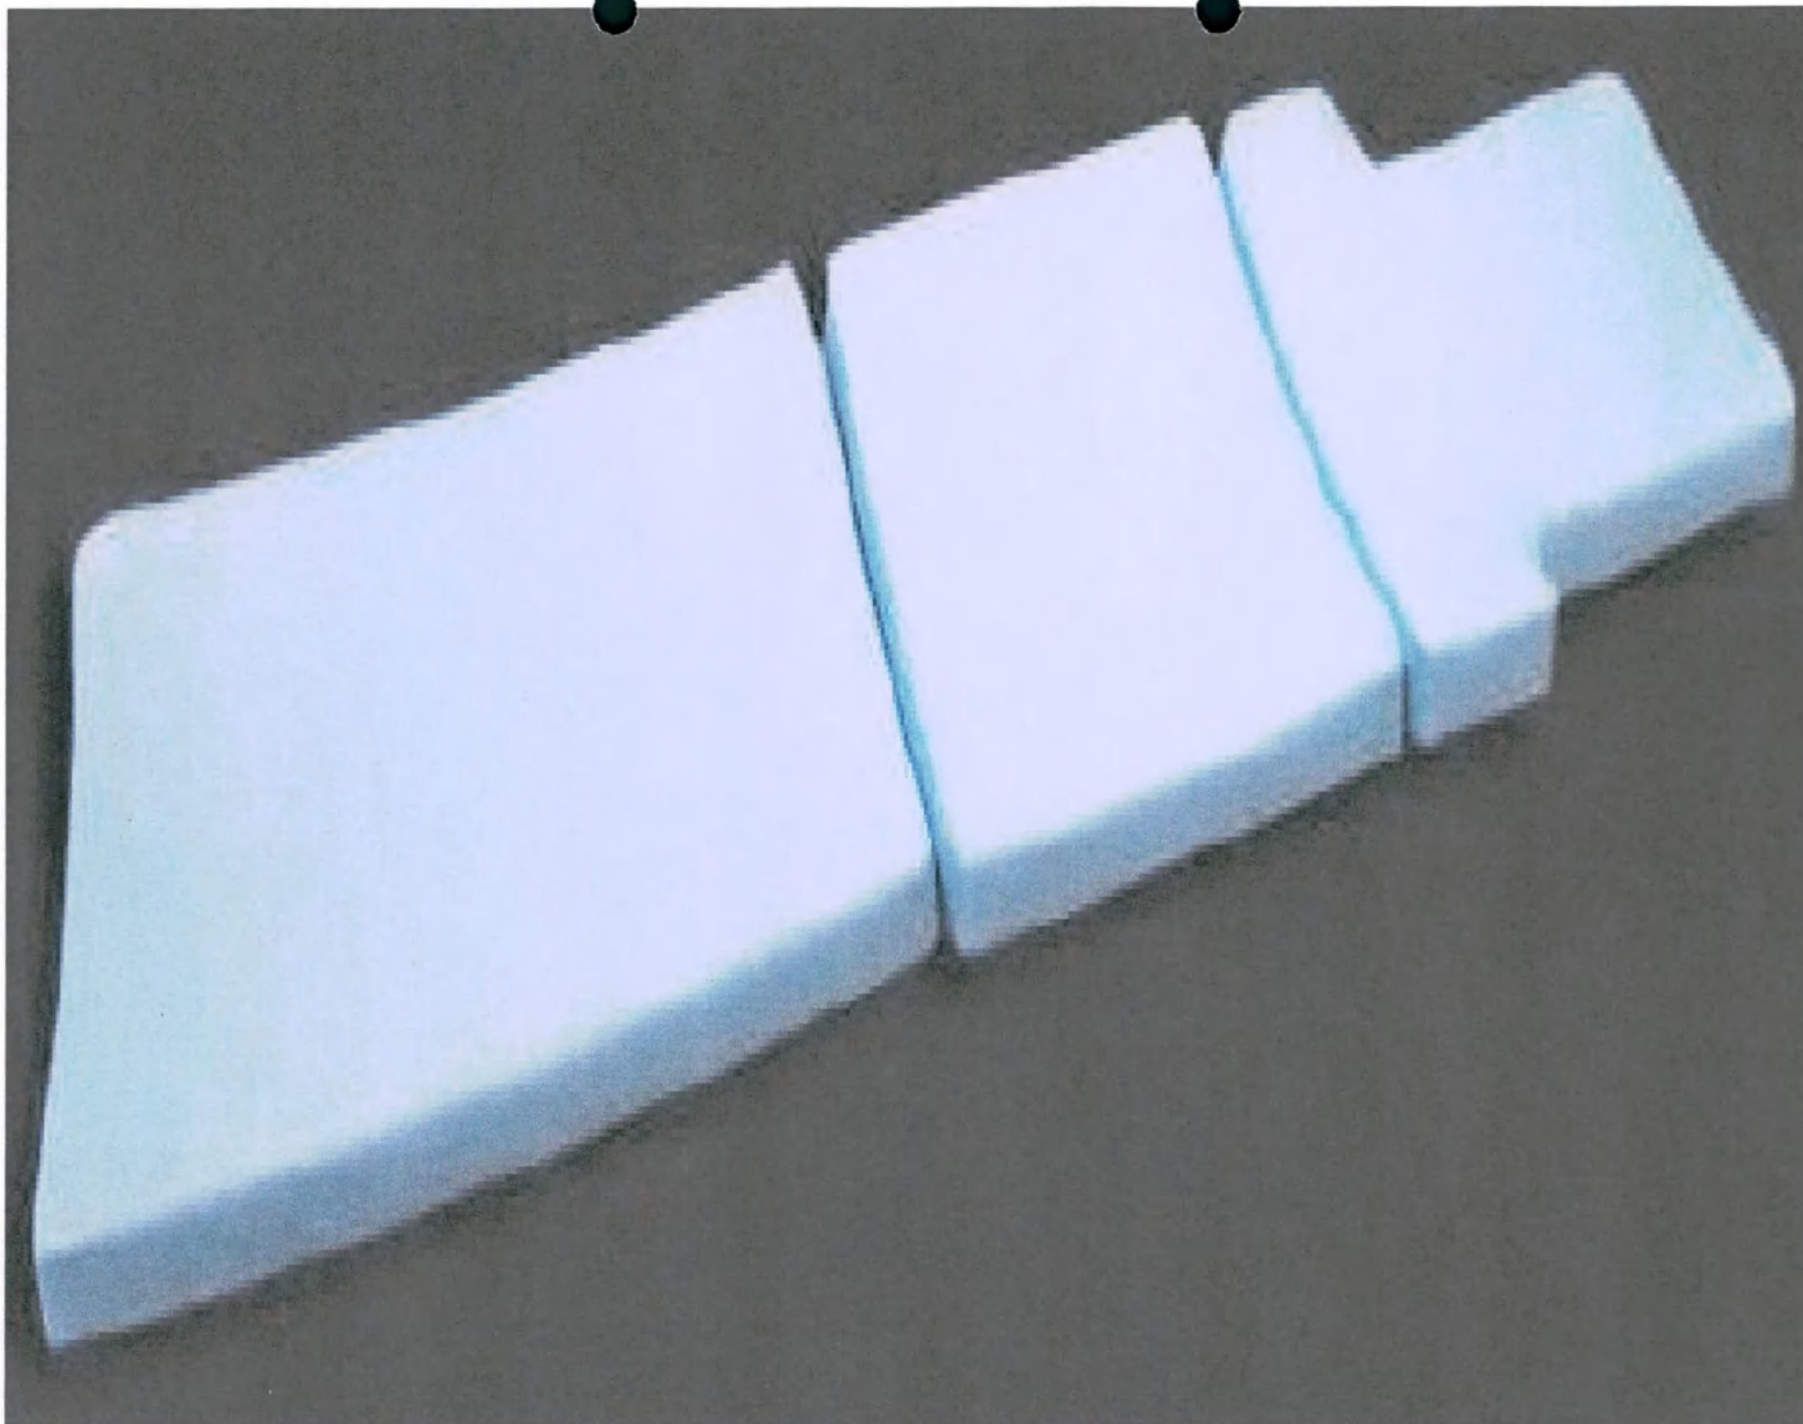


10.2. Медицинский матрас Comfort Plus.

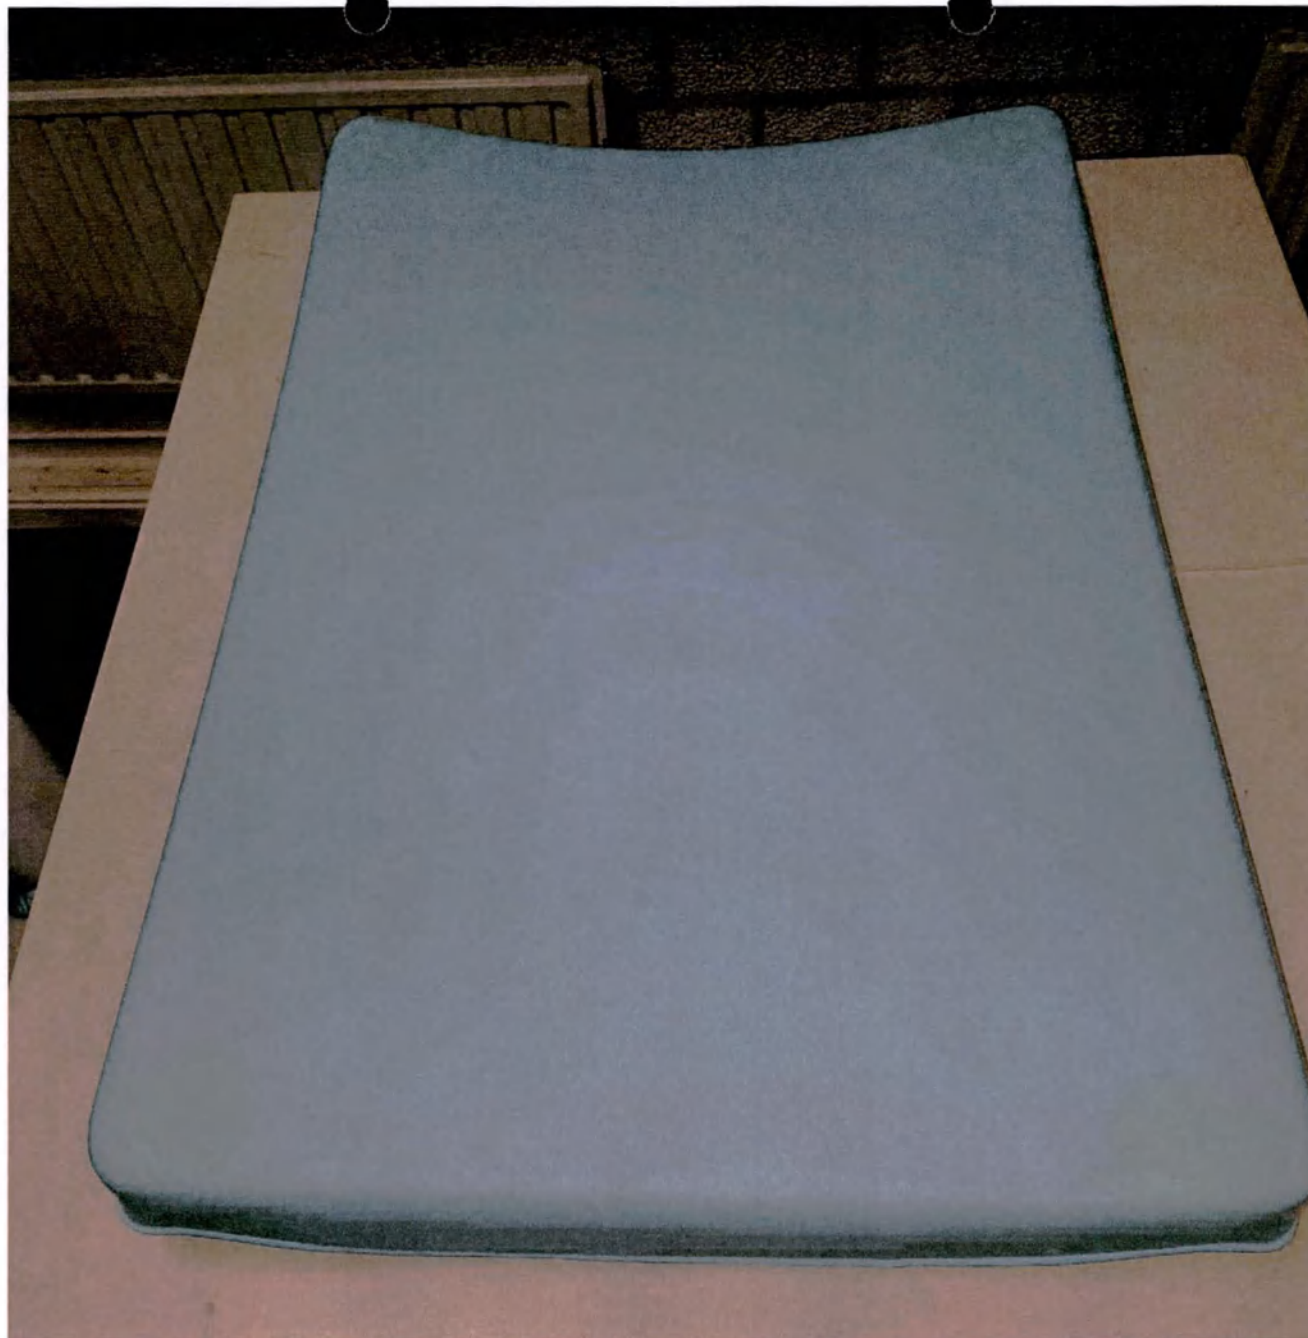


10.2.1 Длинные матрасы (LM).

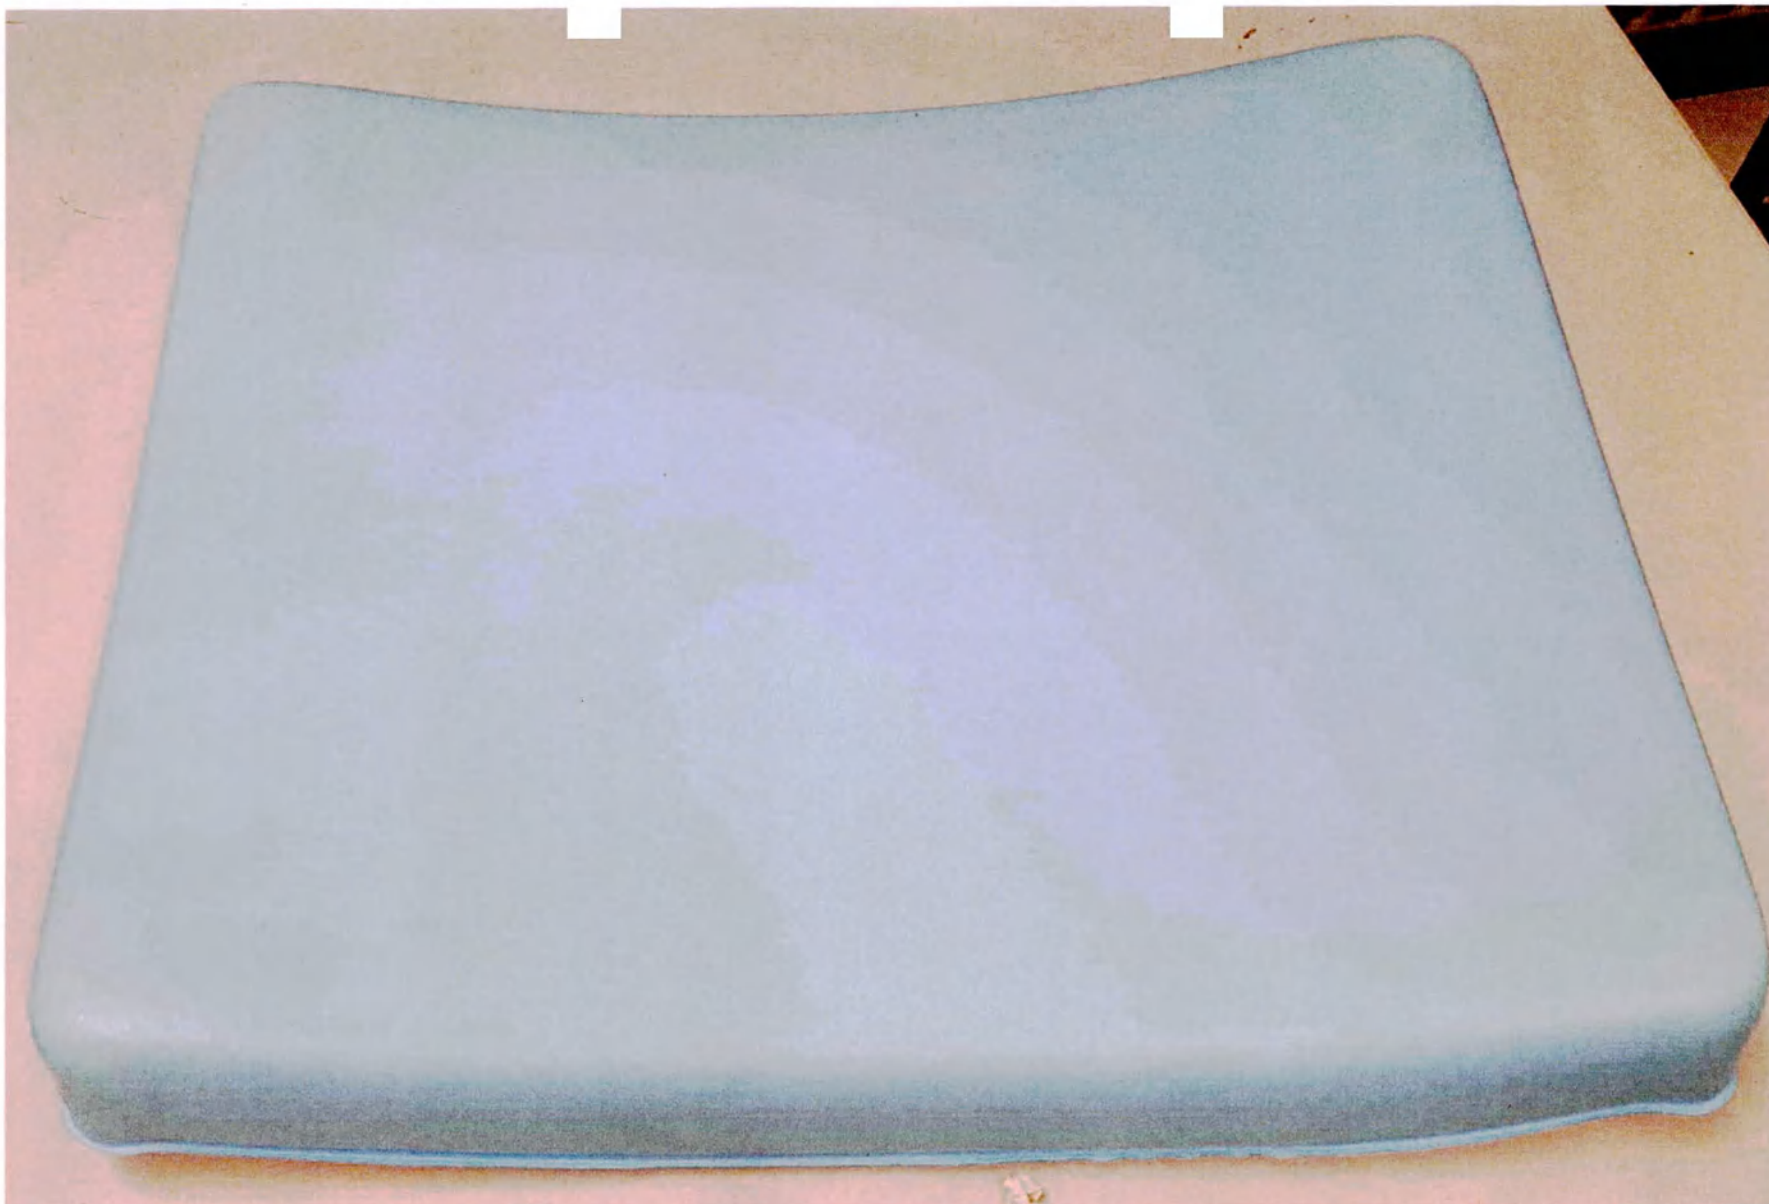

10.2.2 Короткие матрасы (SM).

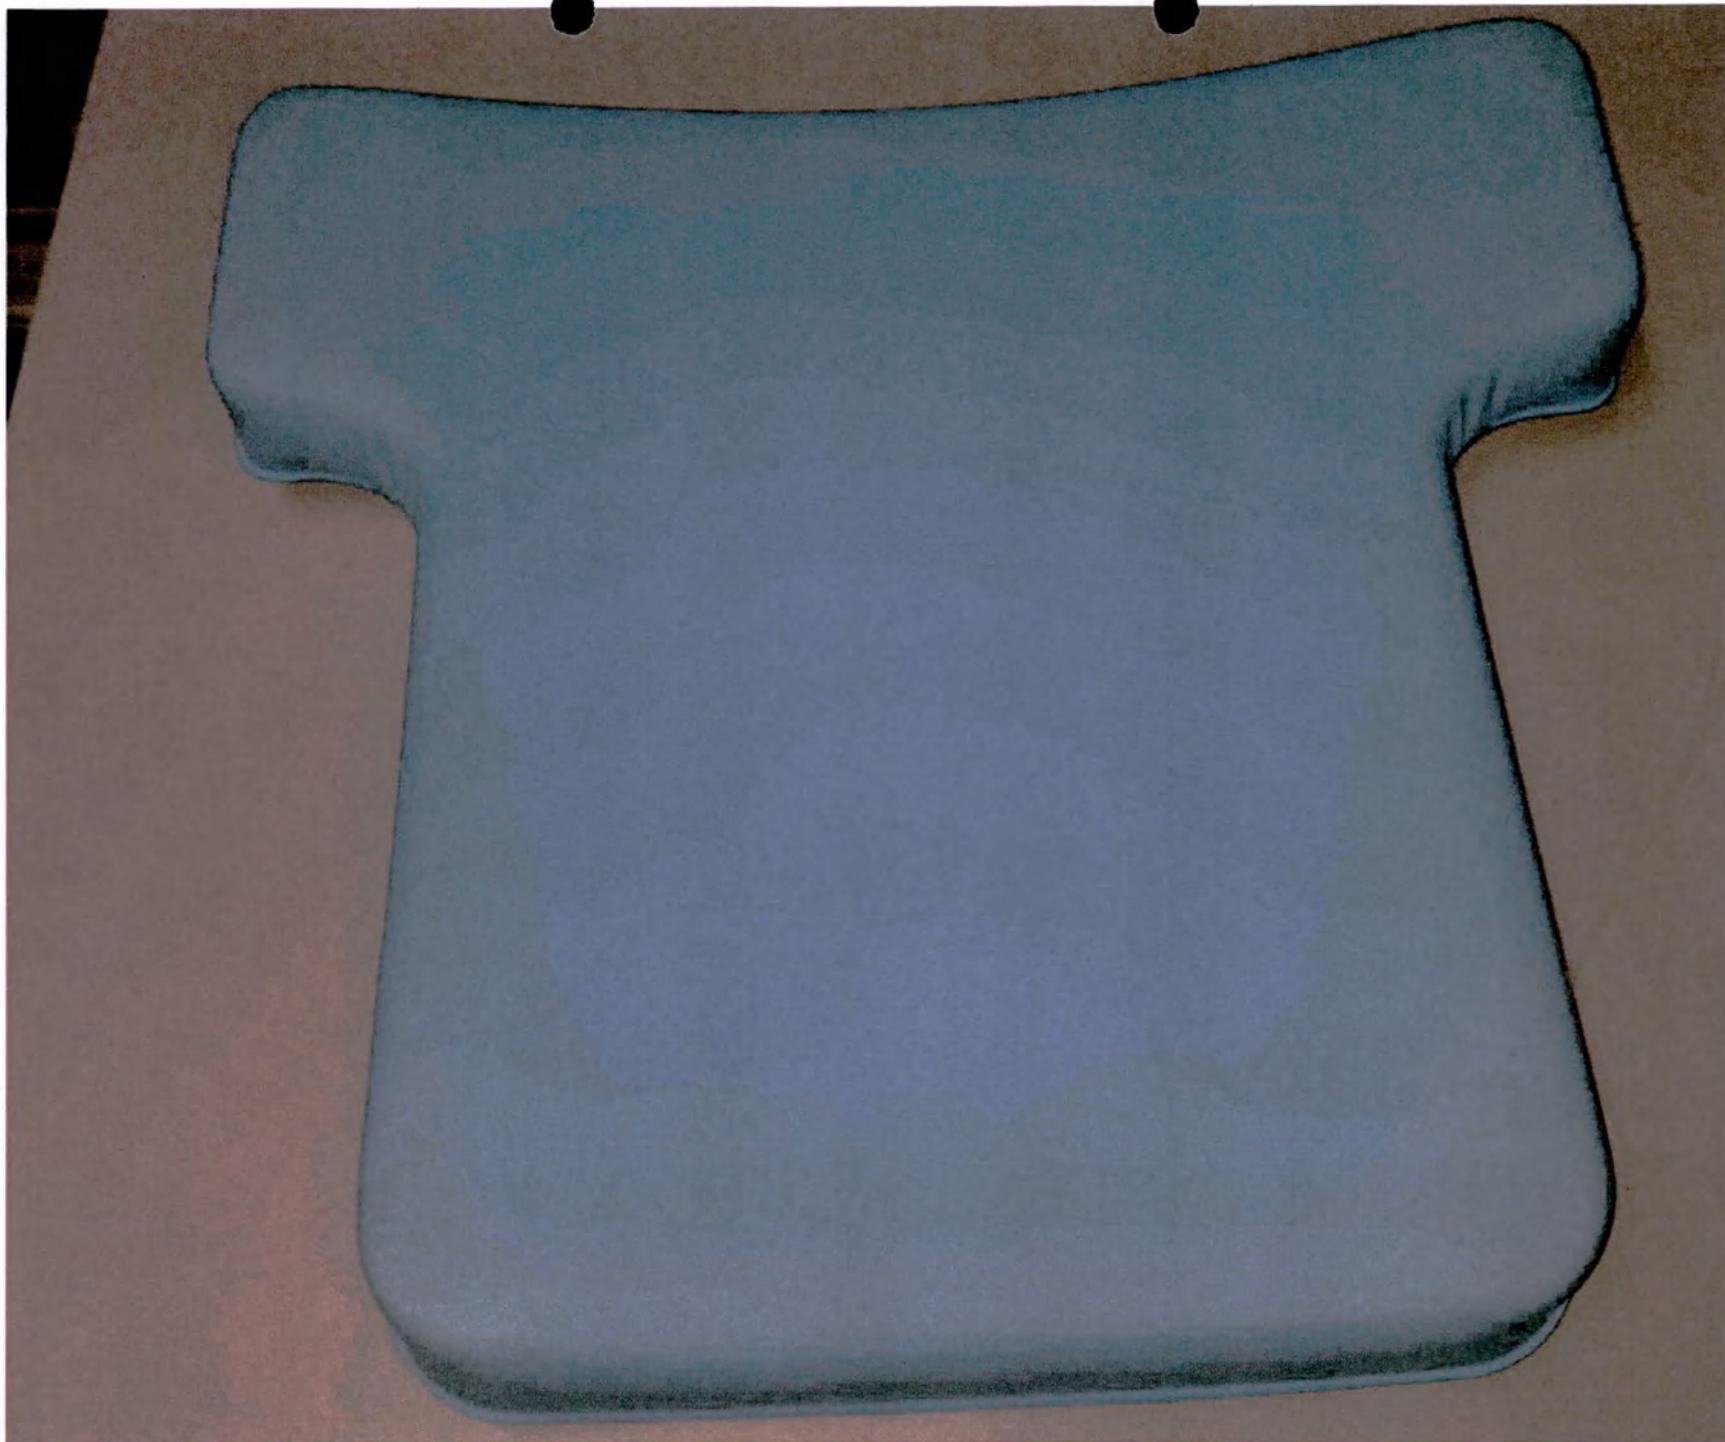

10.2.3 Т-образный матрас (ТМ).

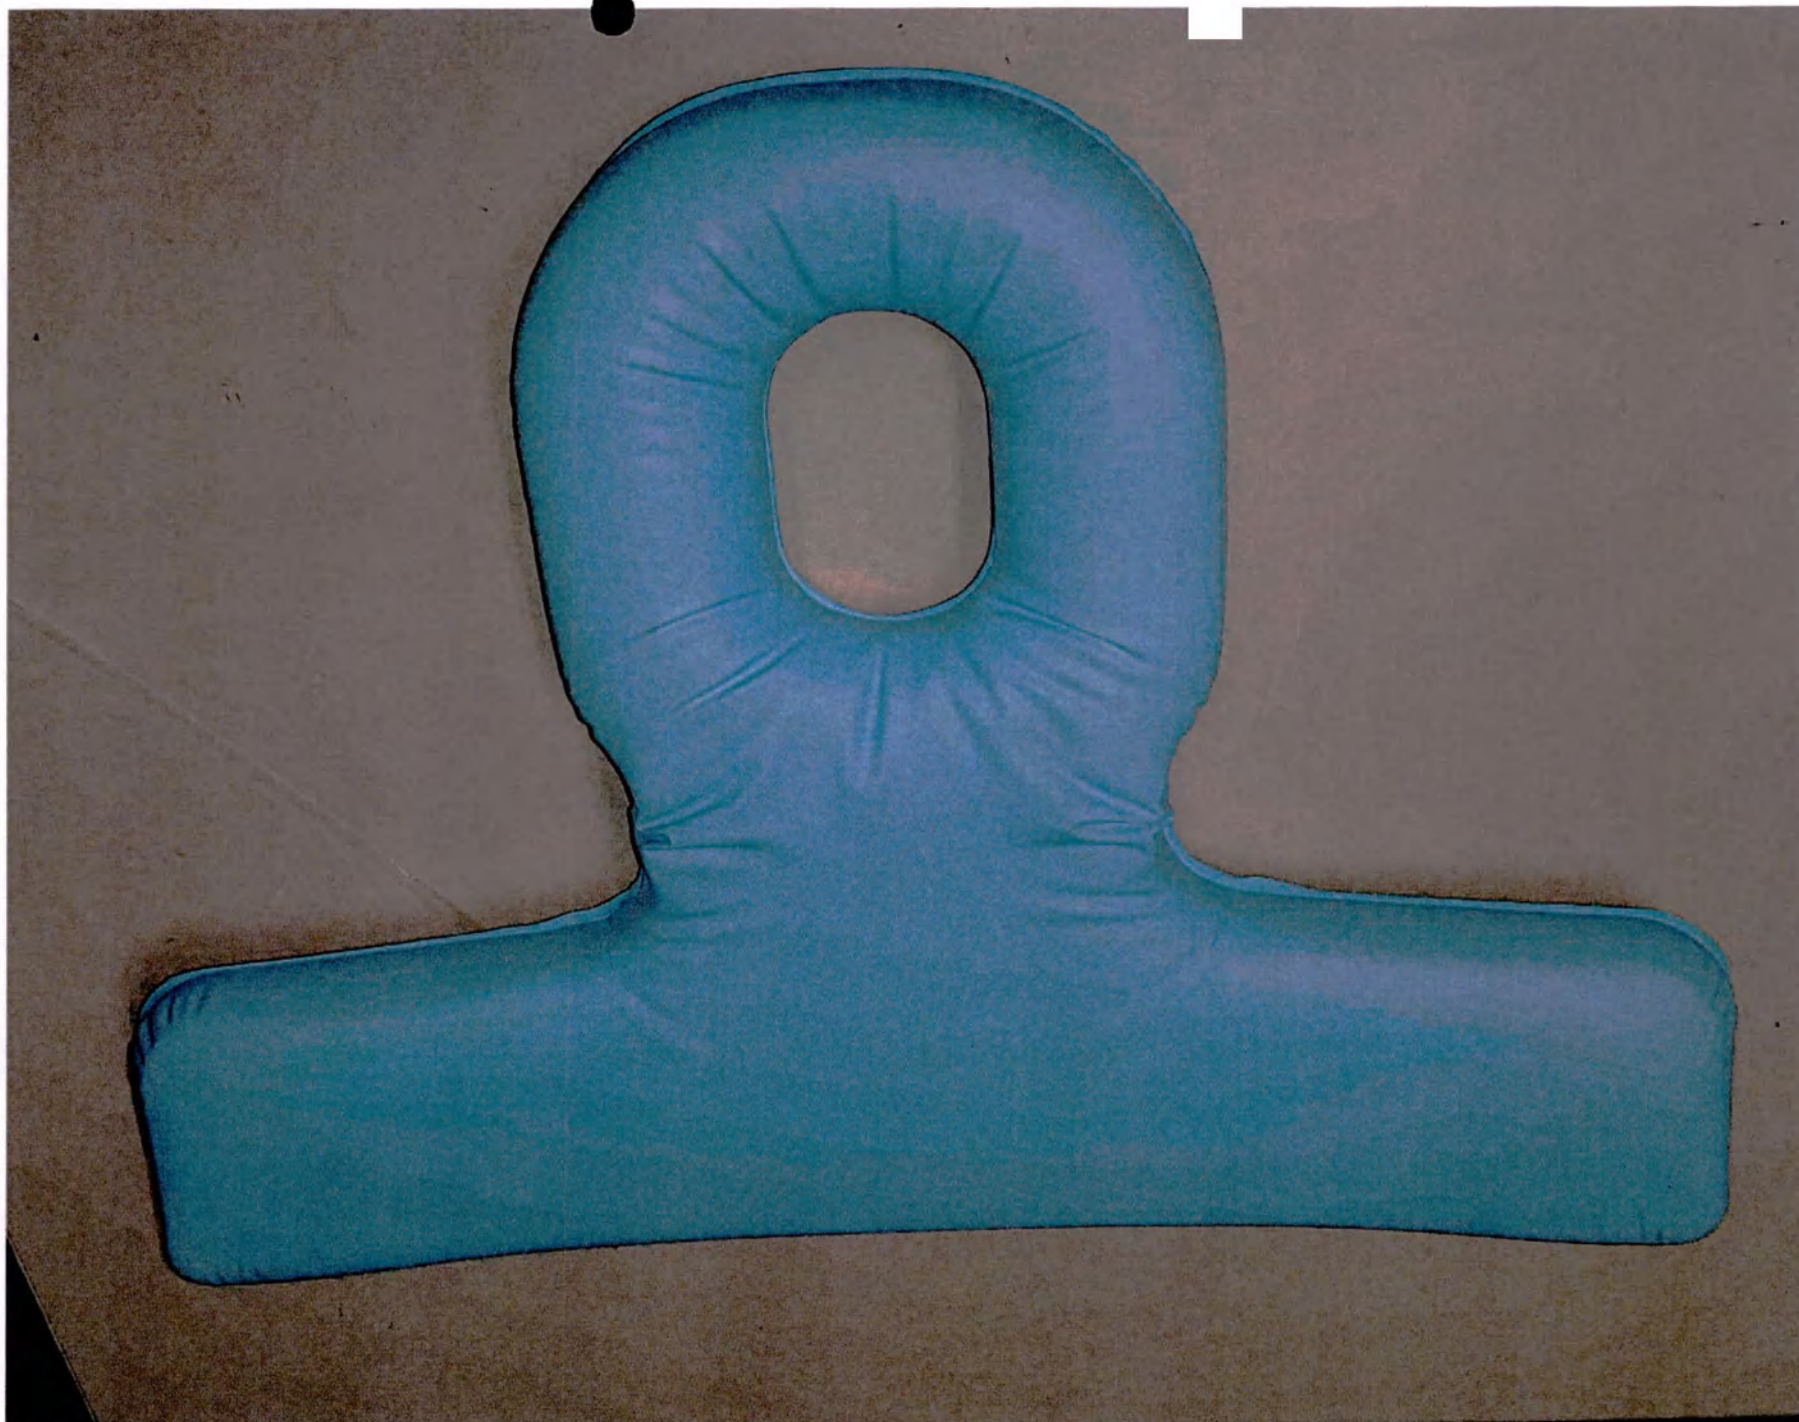

10.3.1 Прокладка для фиксации NVC стандартная.



10.3.2 Тонкая прокладка для фиксации NVC.



10.4. Мешок с песком 3,6 кг.




10.5. Клин 30°.




10.6. Клин 15°.

1598 007 4758


10.7. Клинья из пеноматериала, с размерами 137 мм x 55 мм x 30 мм, и/или с размерами 137 мм x 55 мм x 40 мм, и/или с размерами 137 мм x 55 мм x 50 мм.

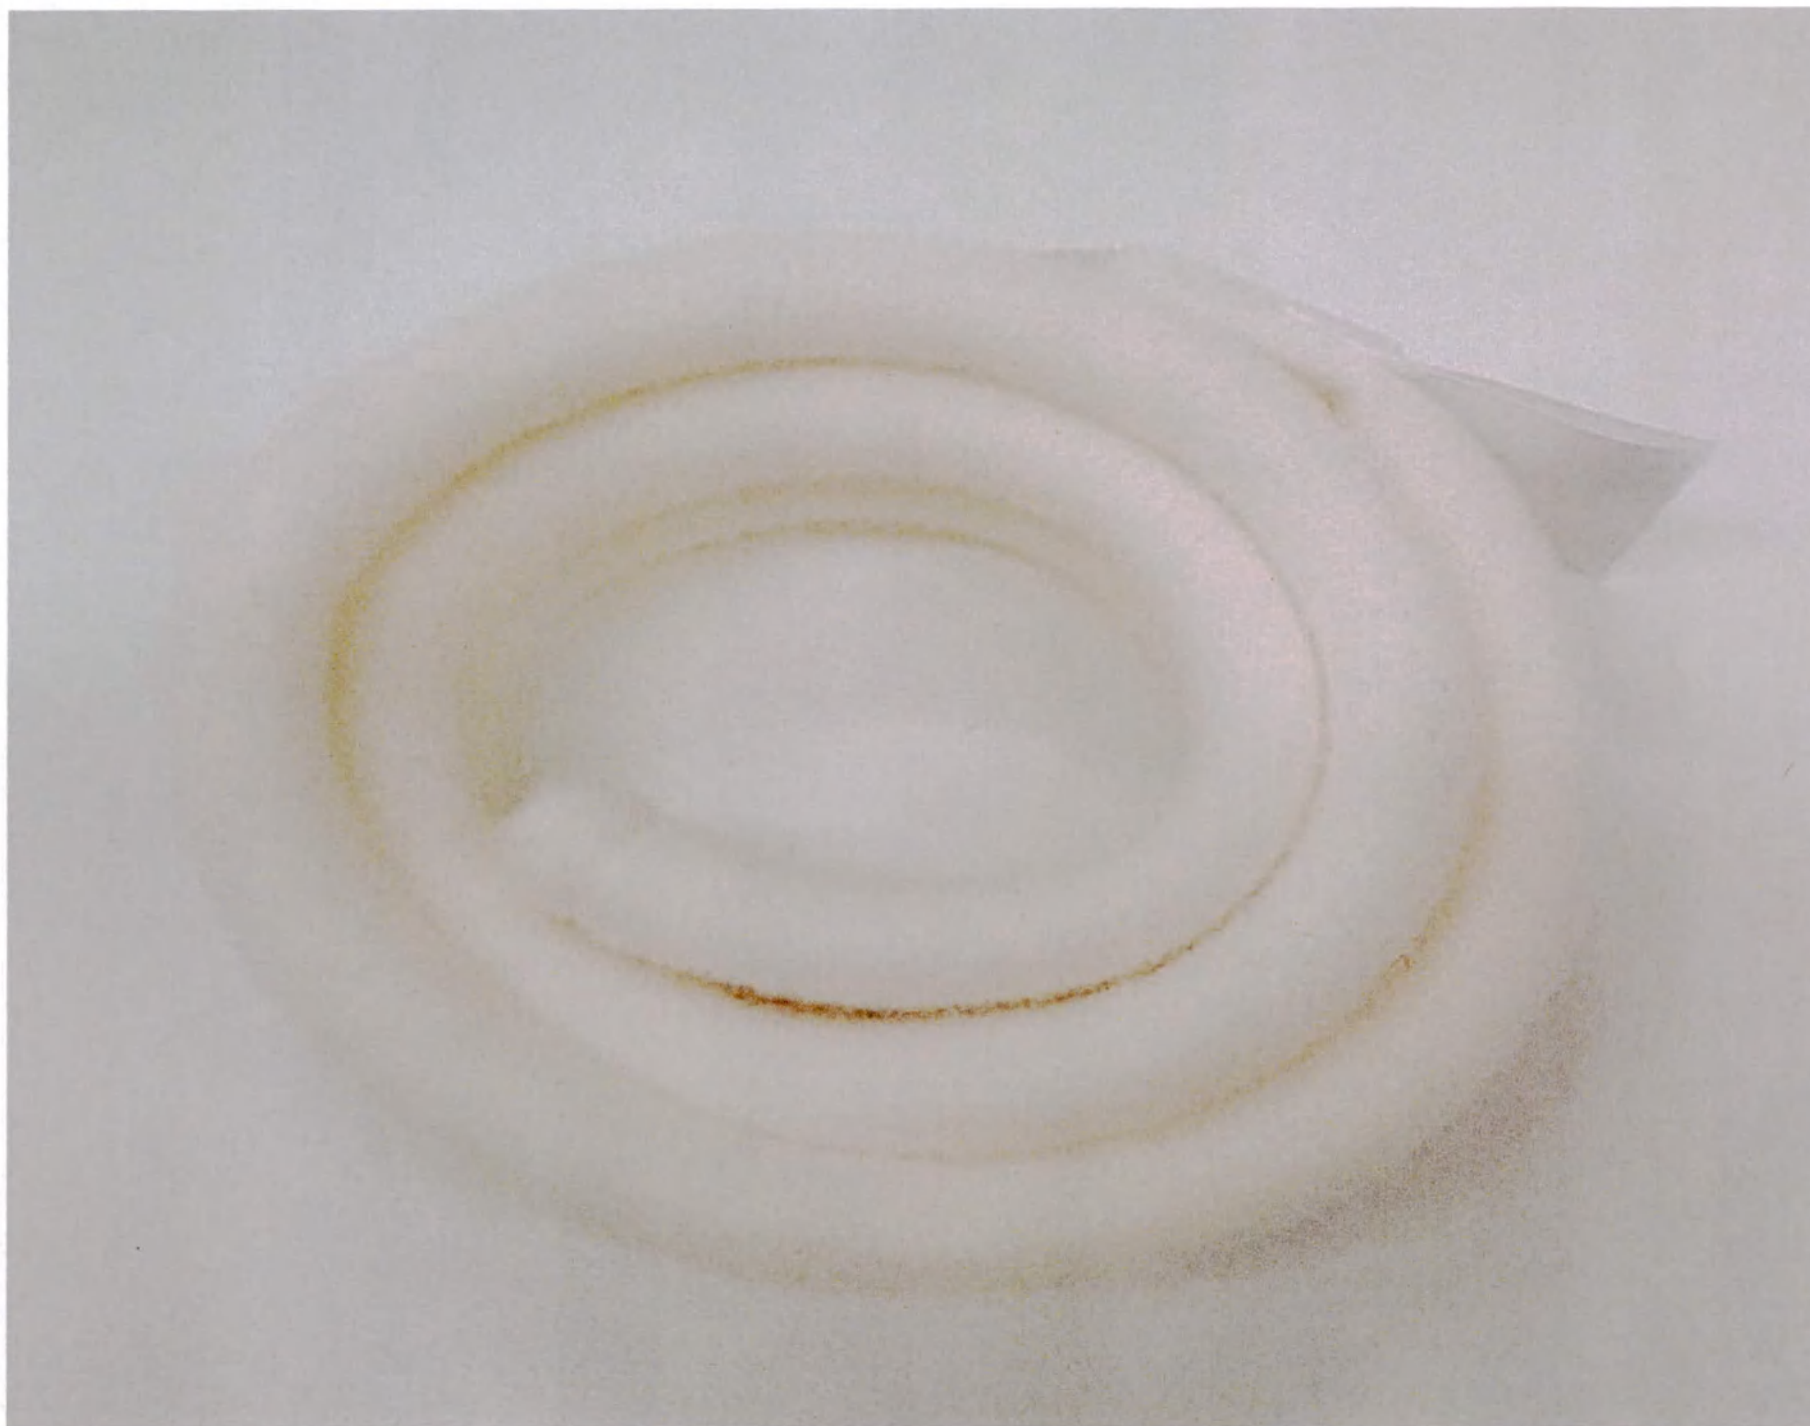


10.8. Ремень для конечностей, среднего размера.

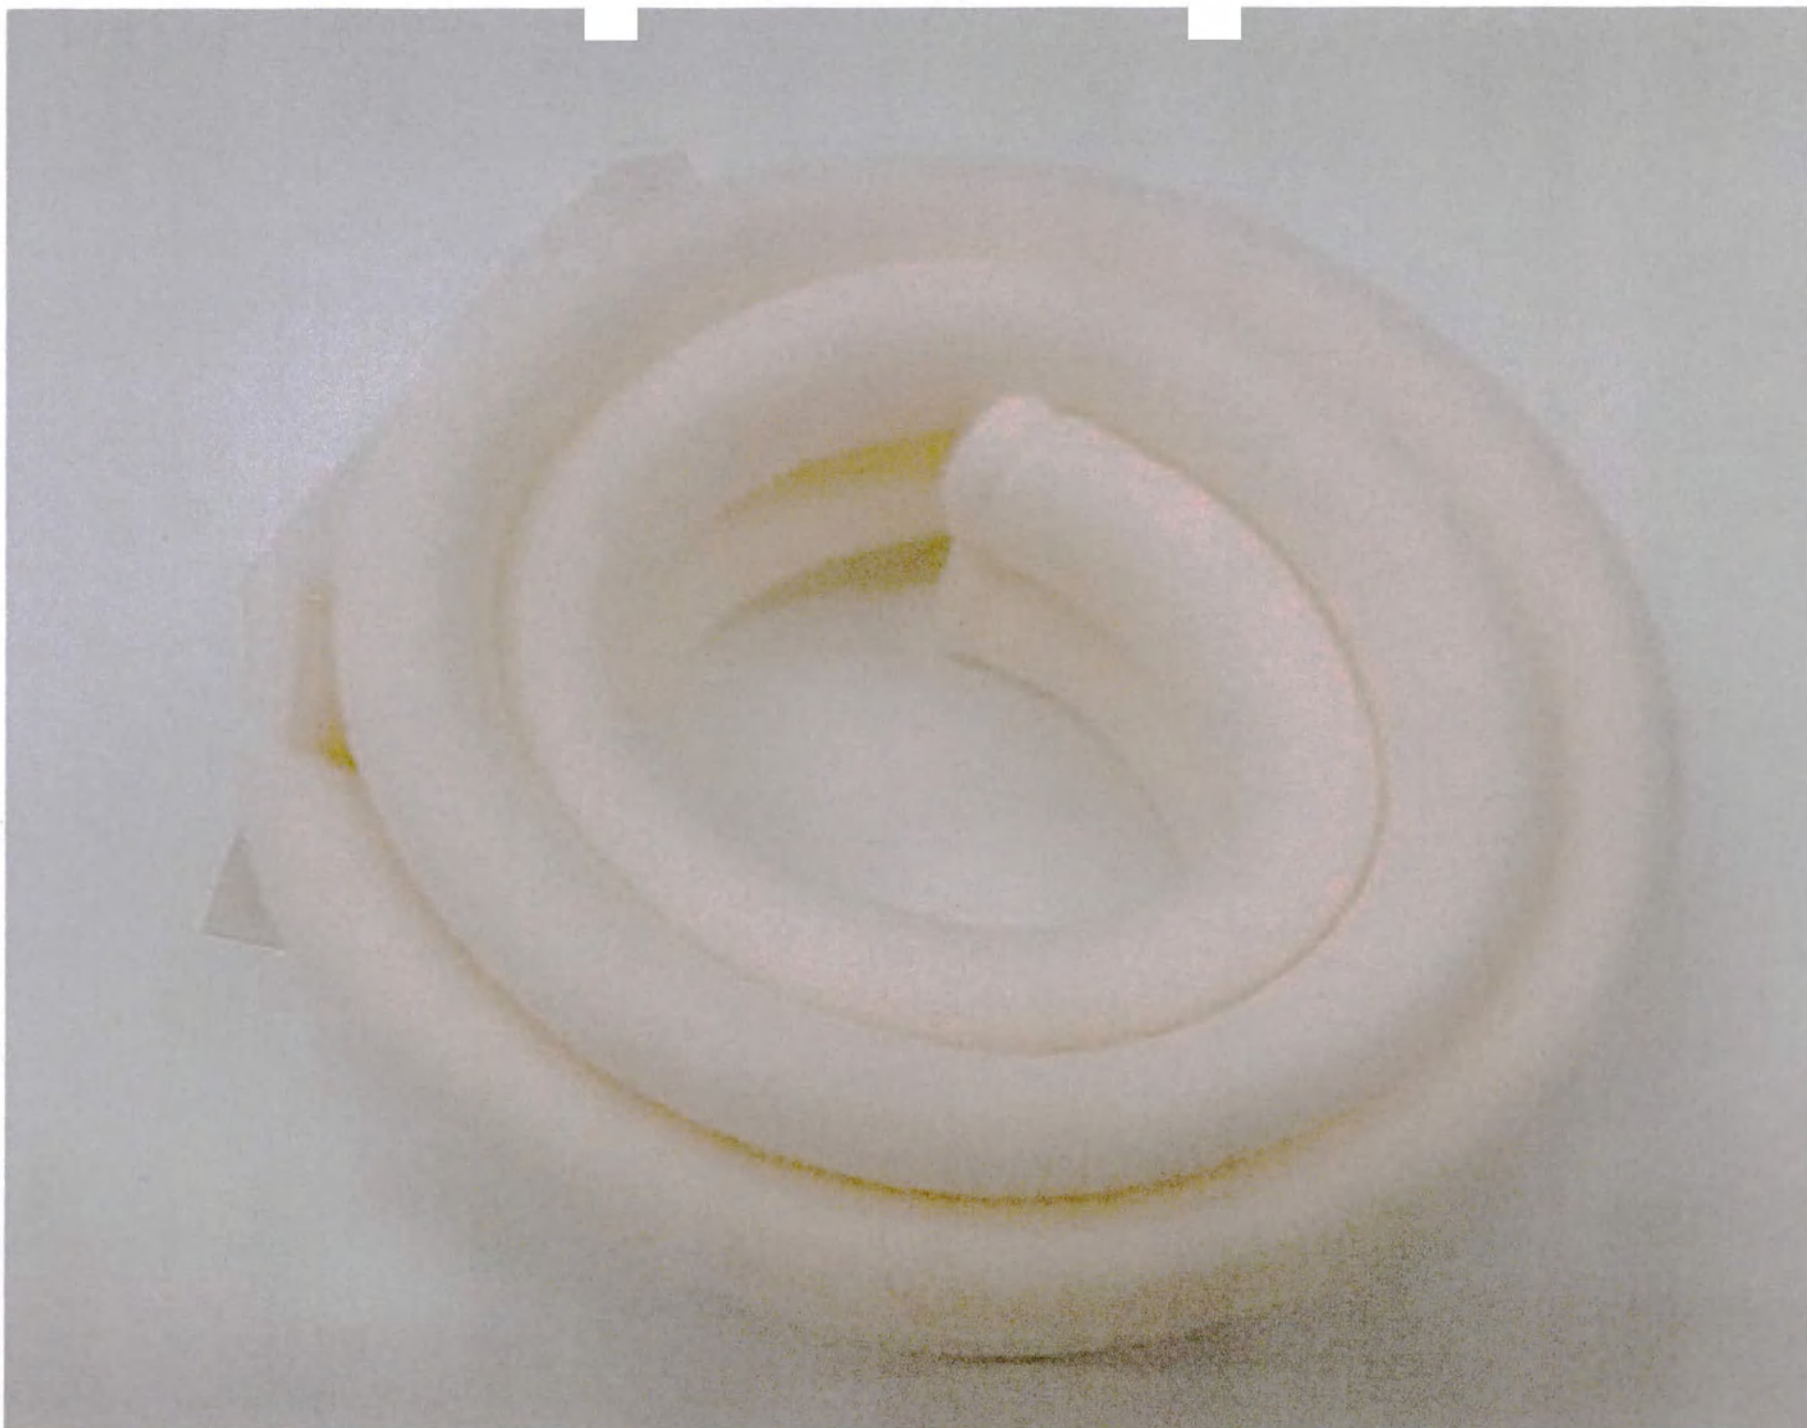


10.9. Ремень для конечностей, большого размера.

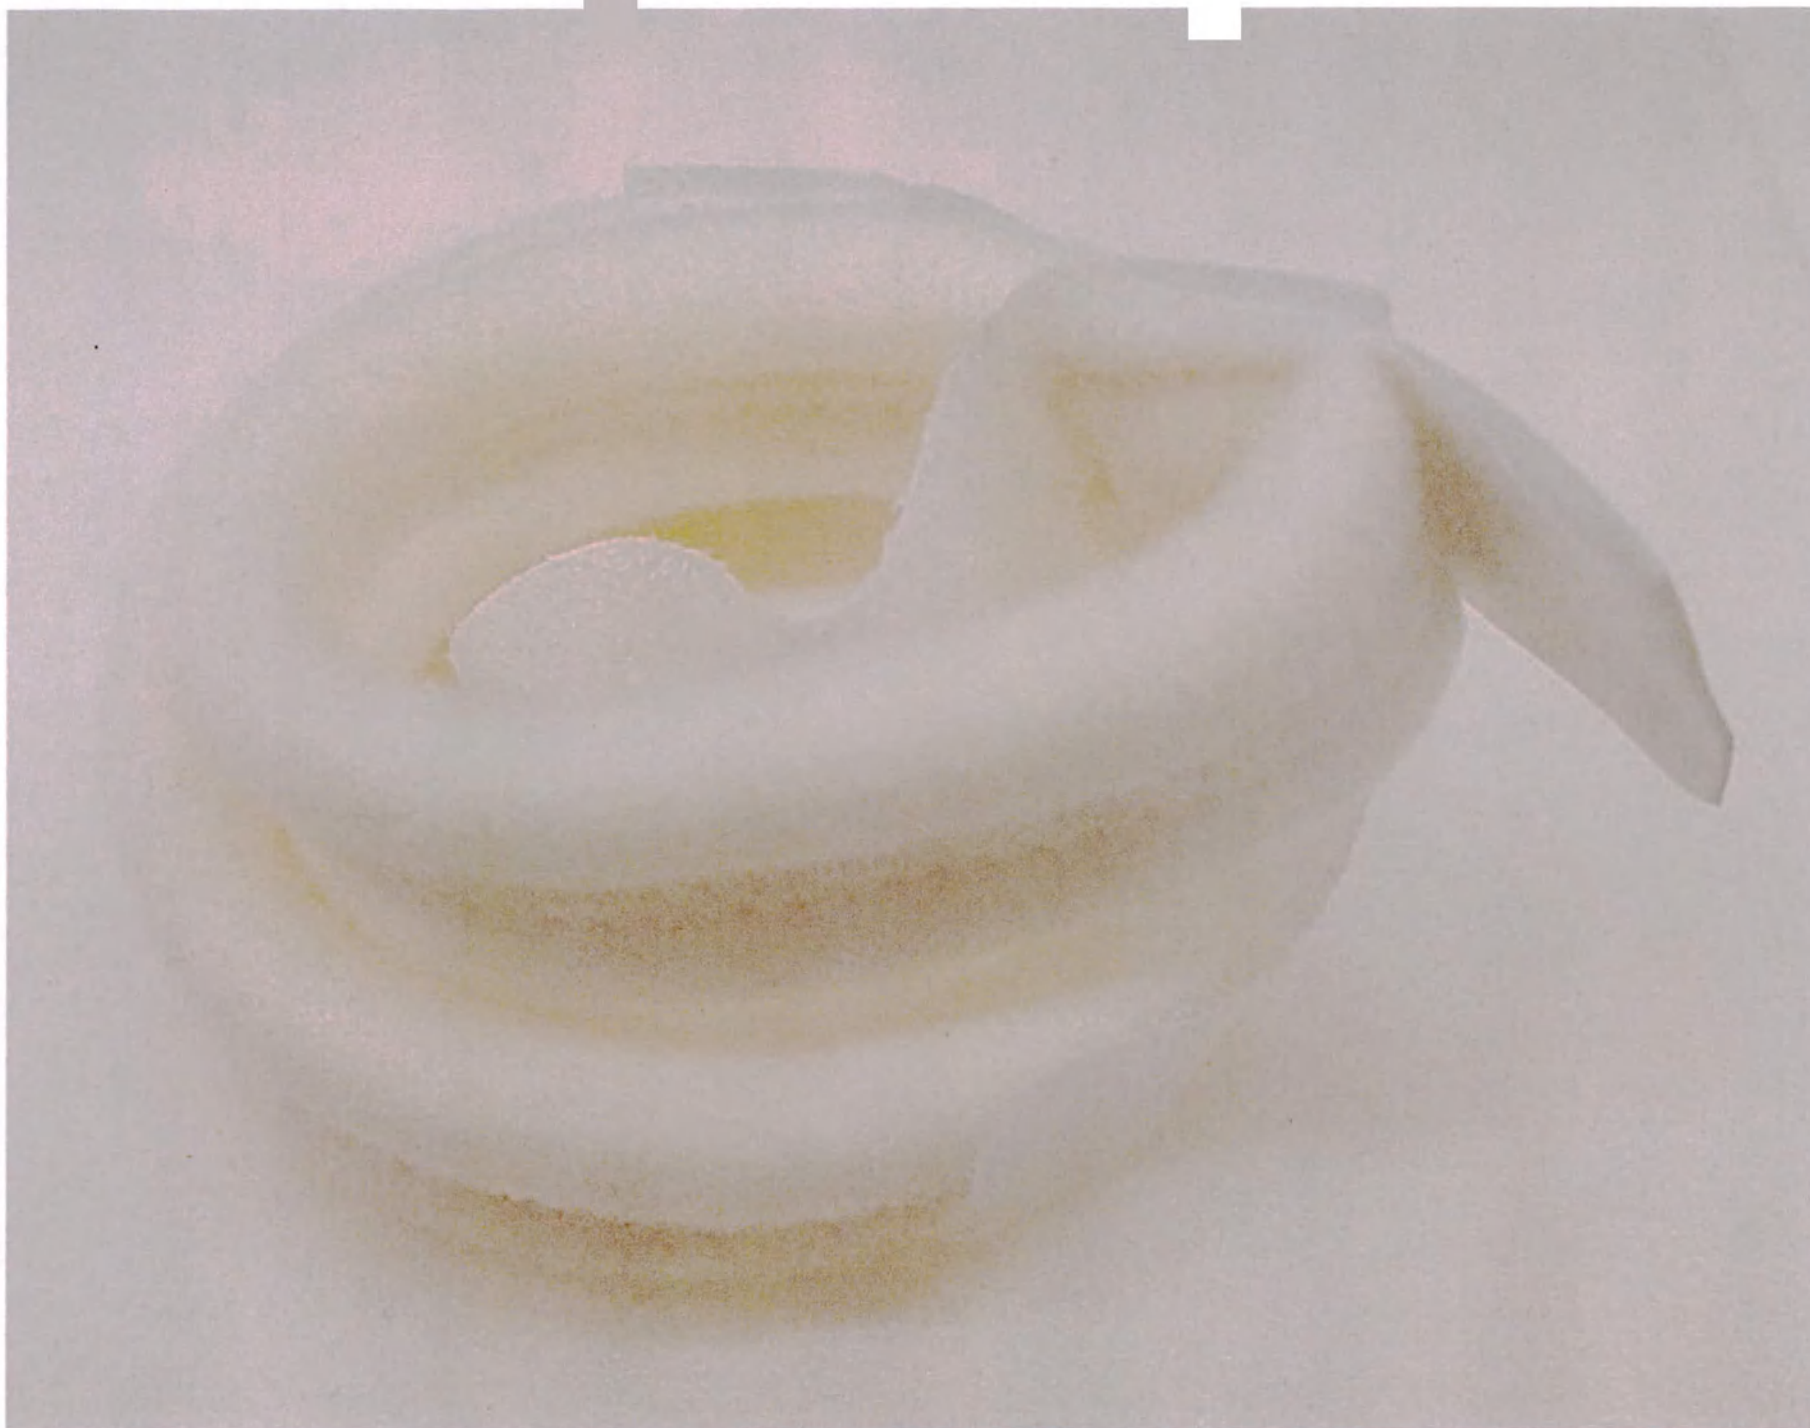

10.10. Ремень для головы/глазниц.

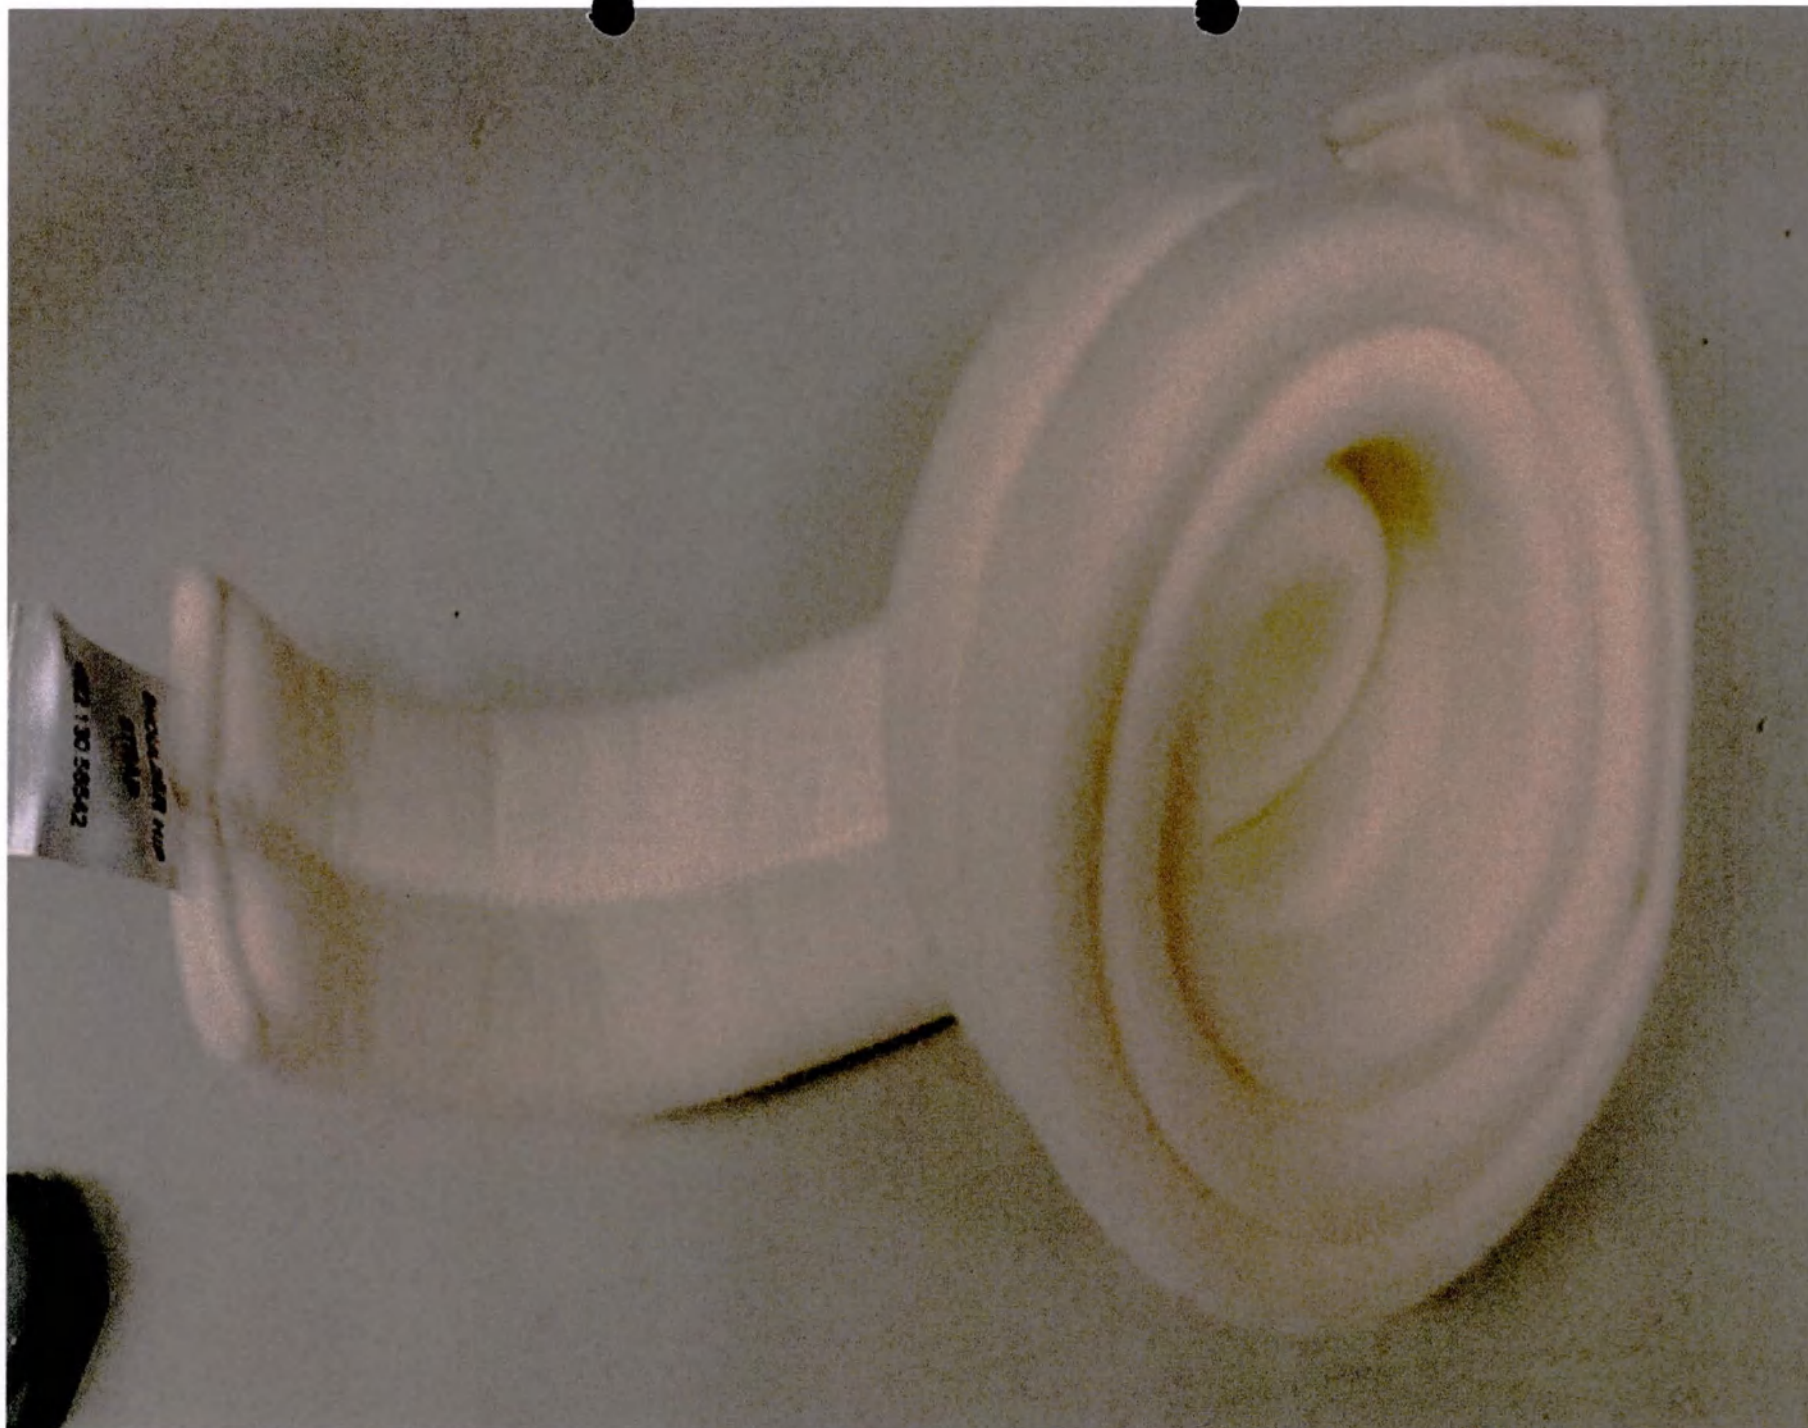


10.11. Ремень для плеча/бедра.

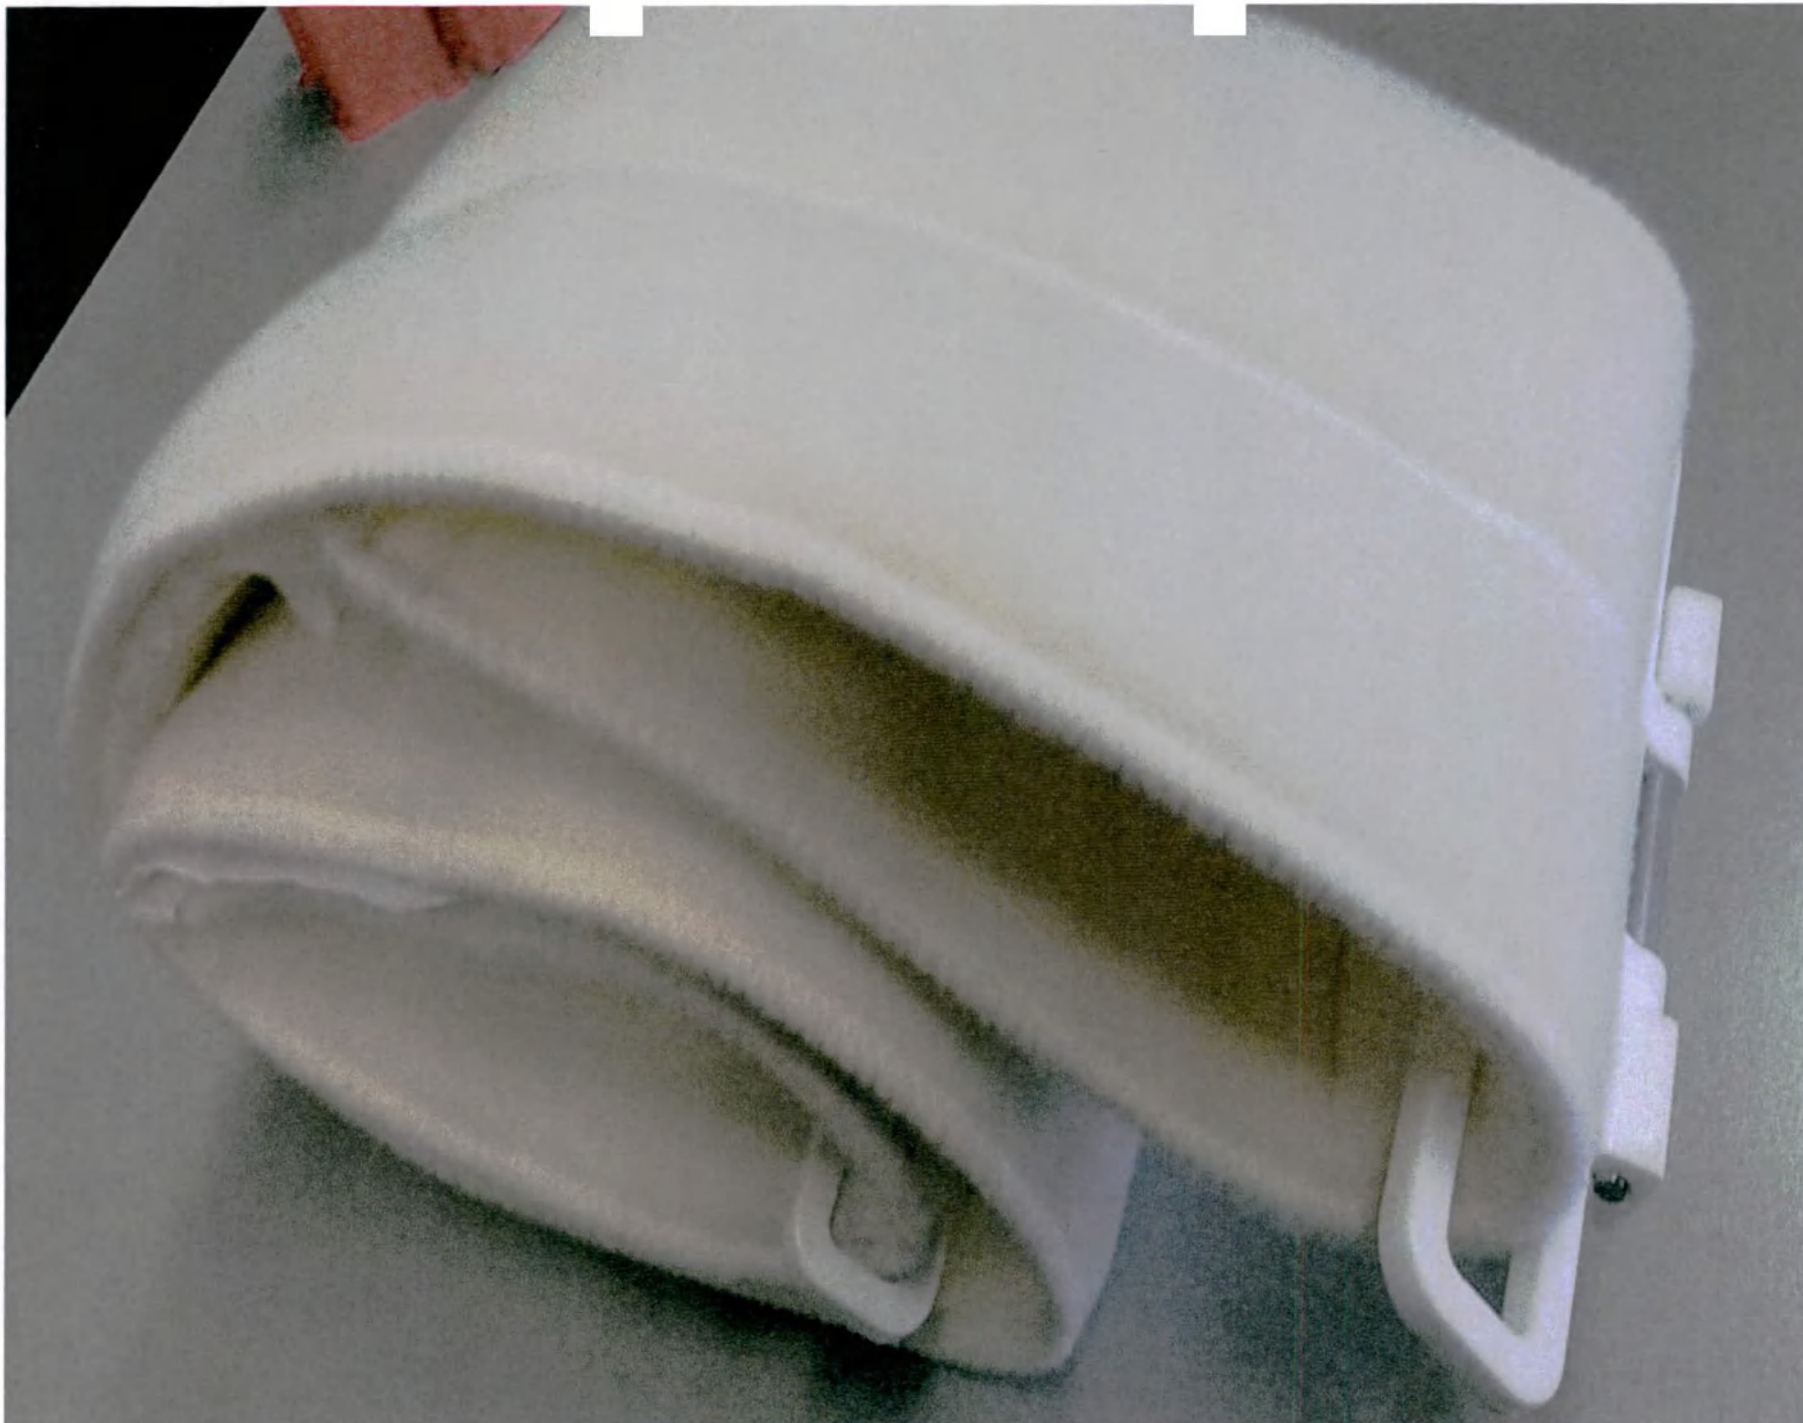

10.12. Мягкий ремень для тела.




10.13. Опора для колен.

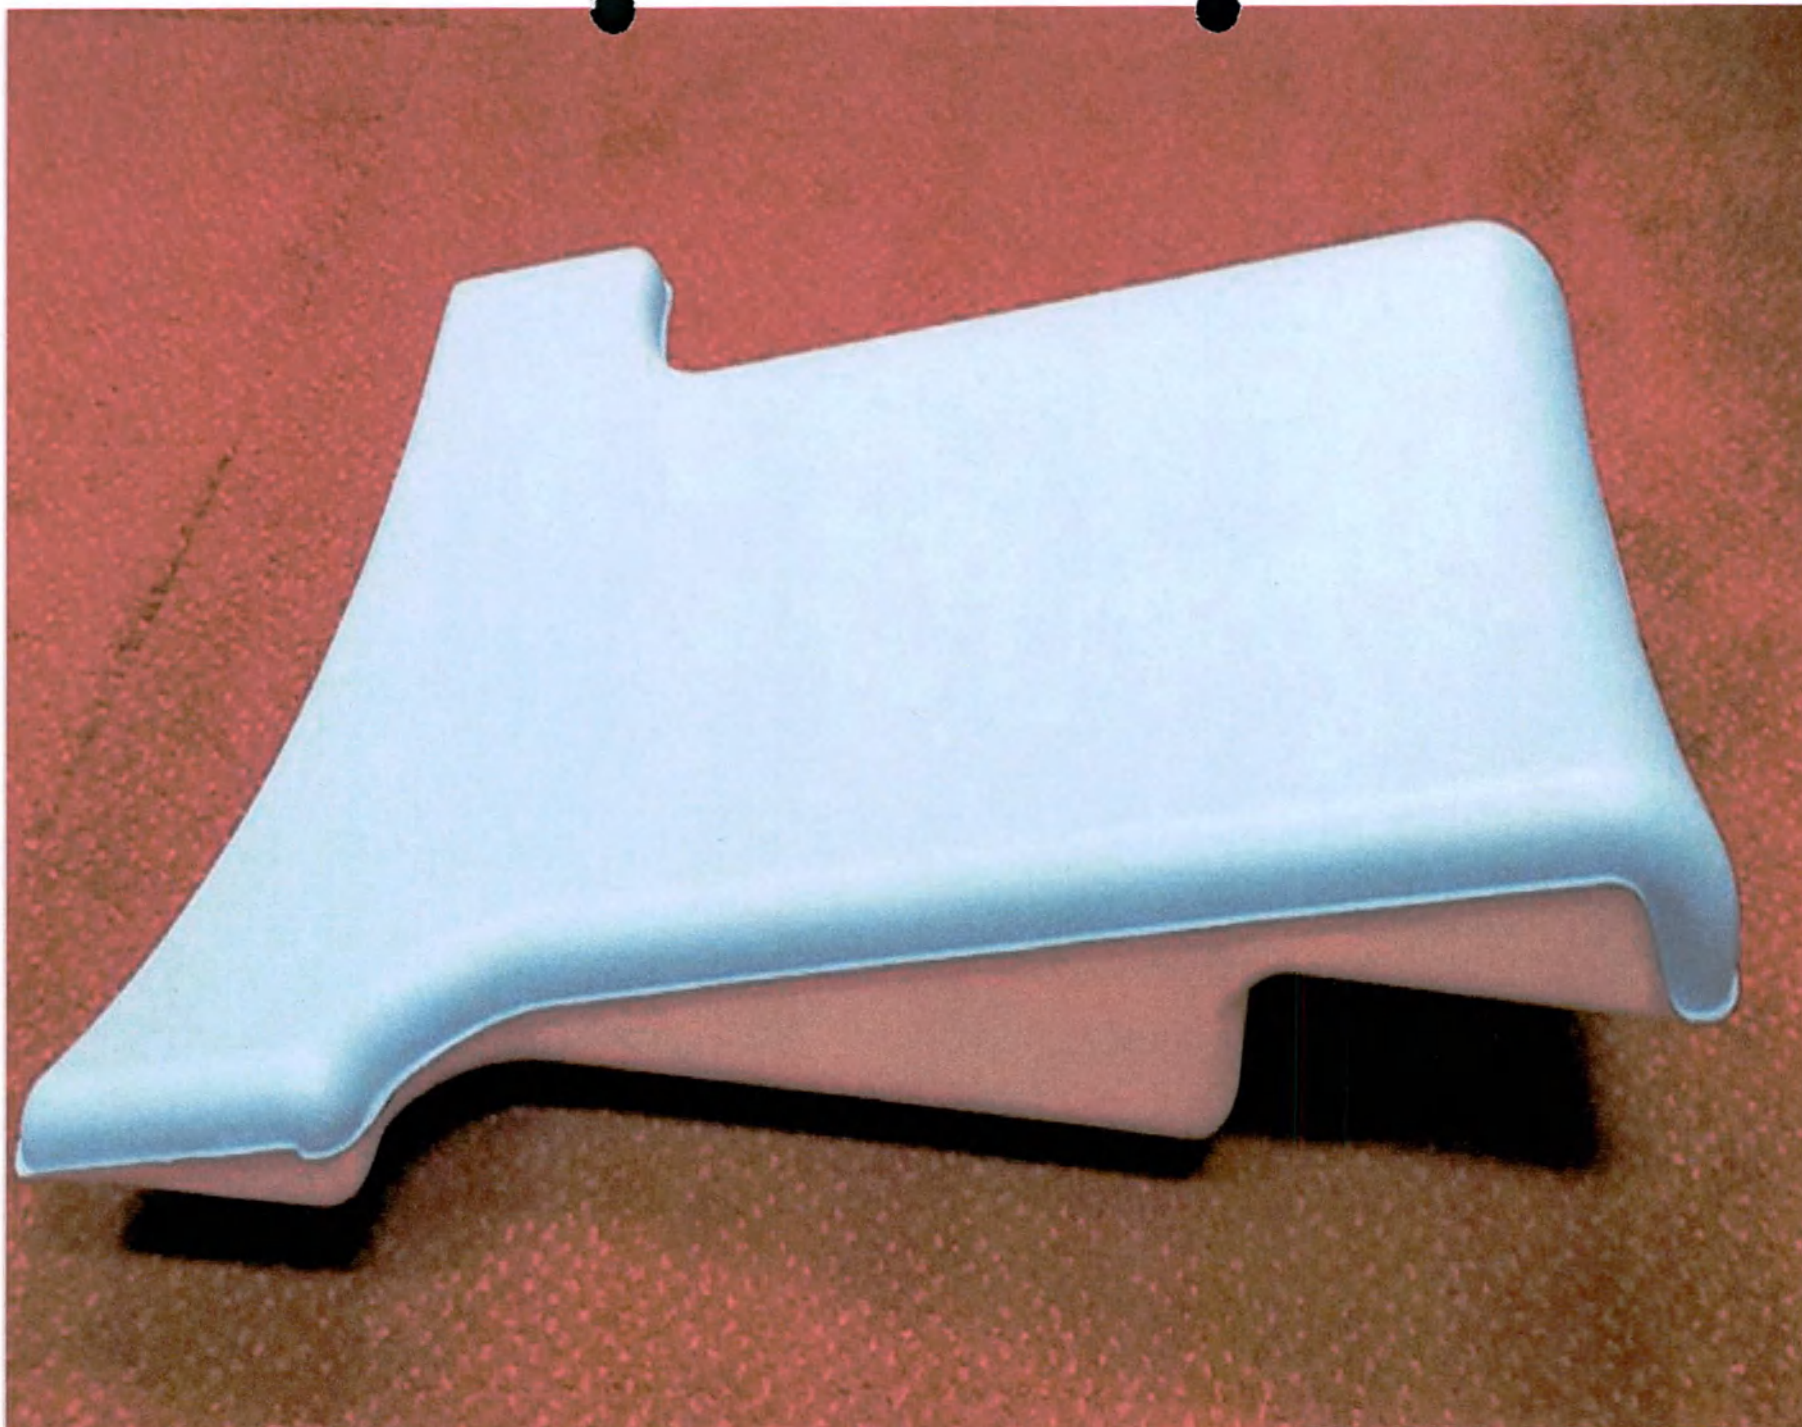

10.14. Опора для головы/ног.




10.15. Опора для рук.

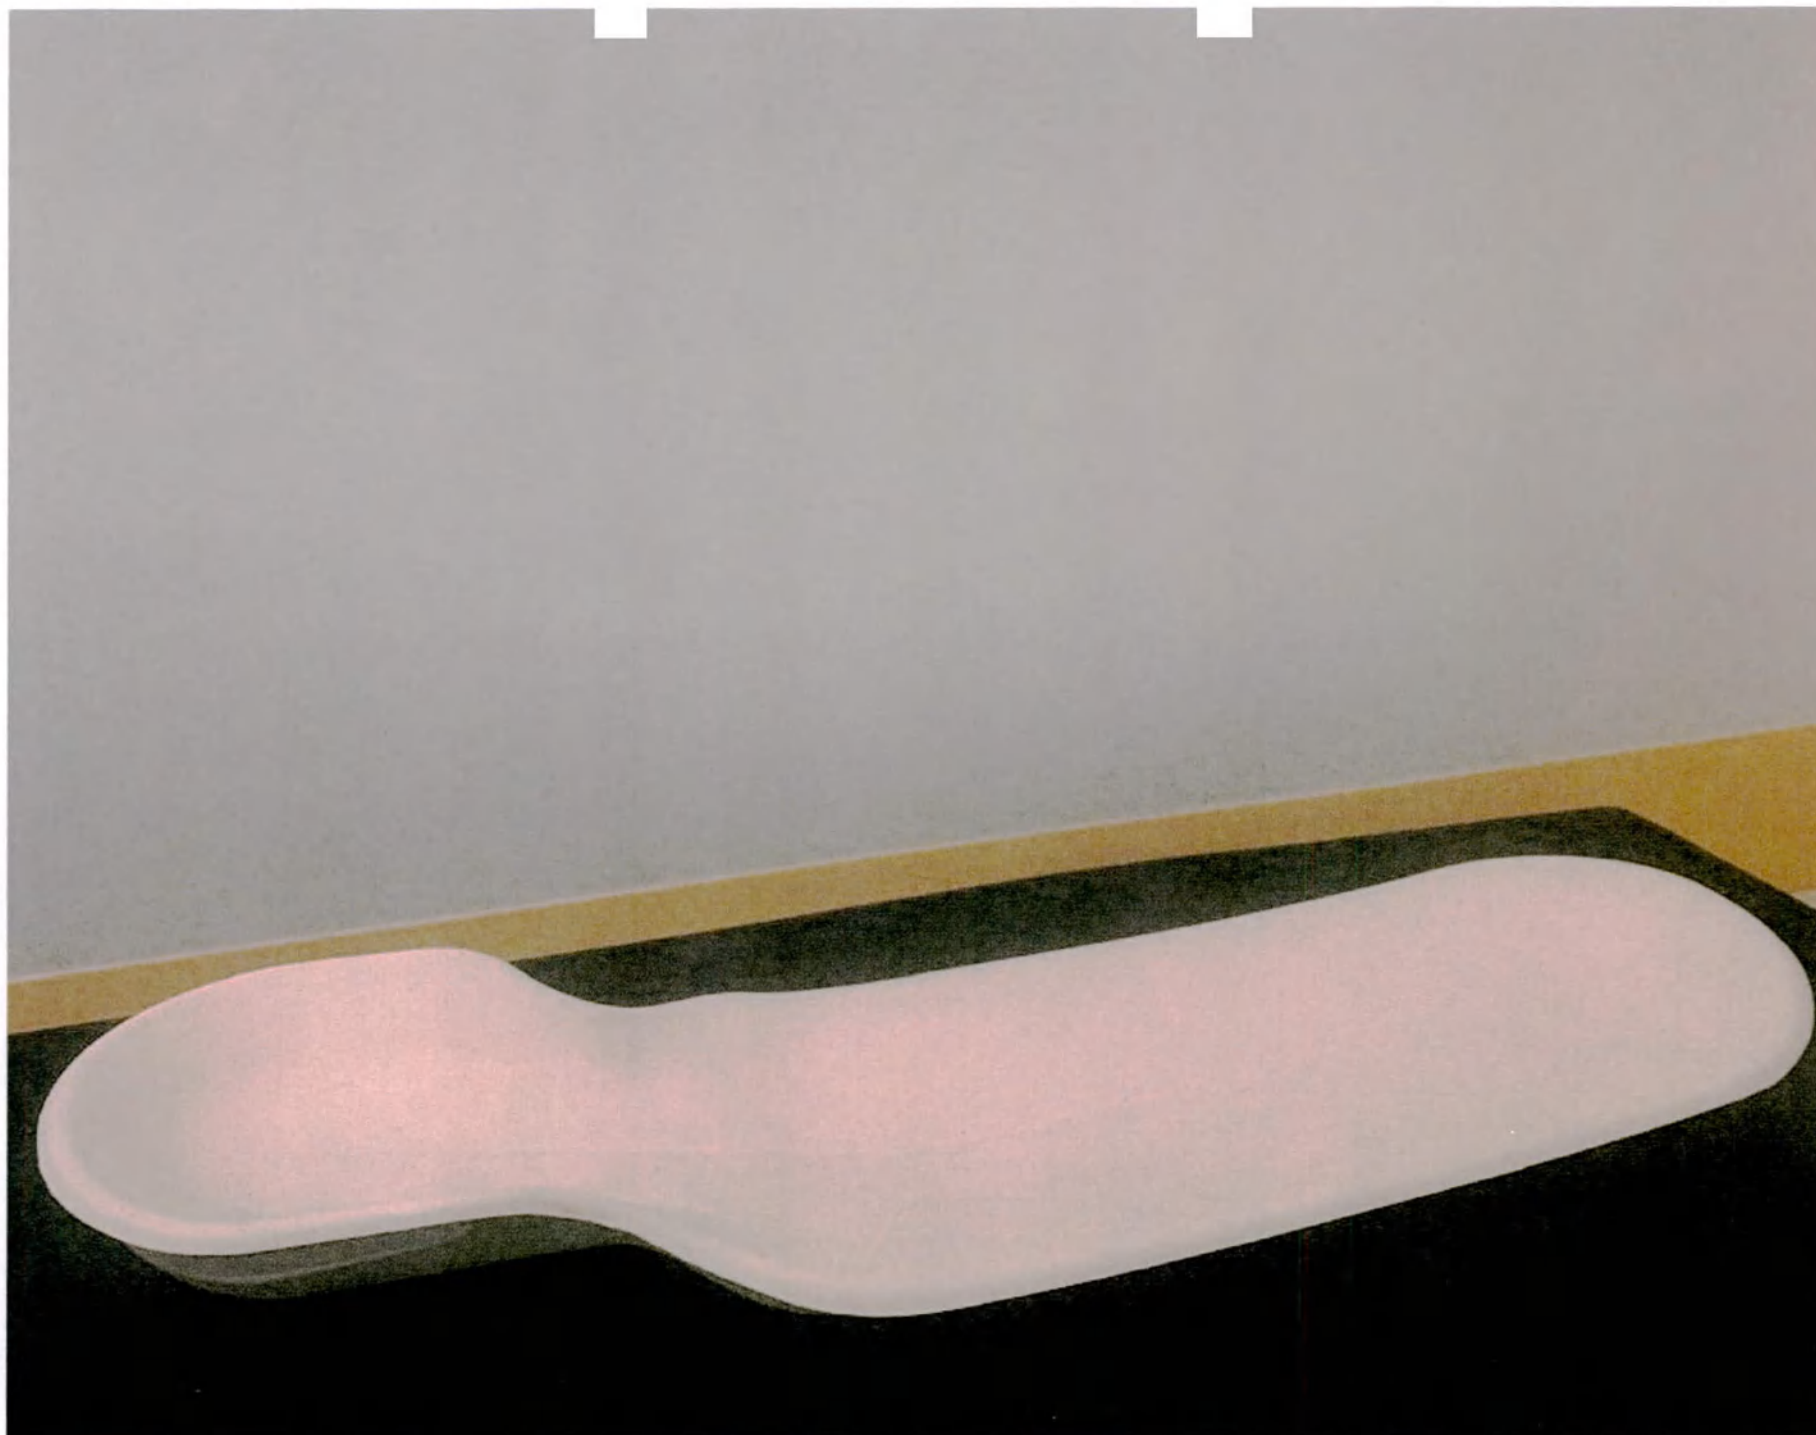

10.16. Опора для грудных детей.



10.17. Детский ремень среднего размера.
10.18. Детский ремень большого размера.

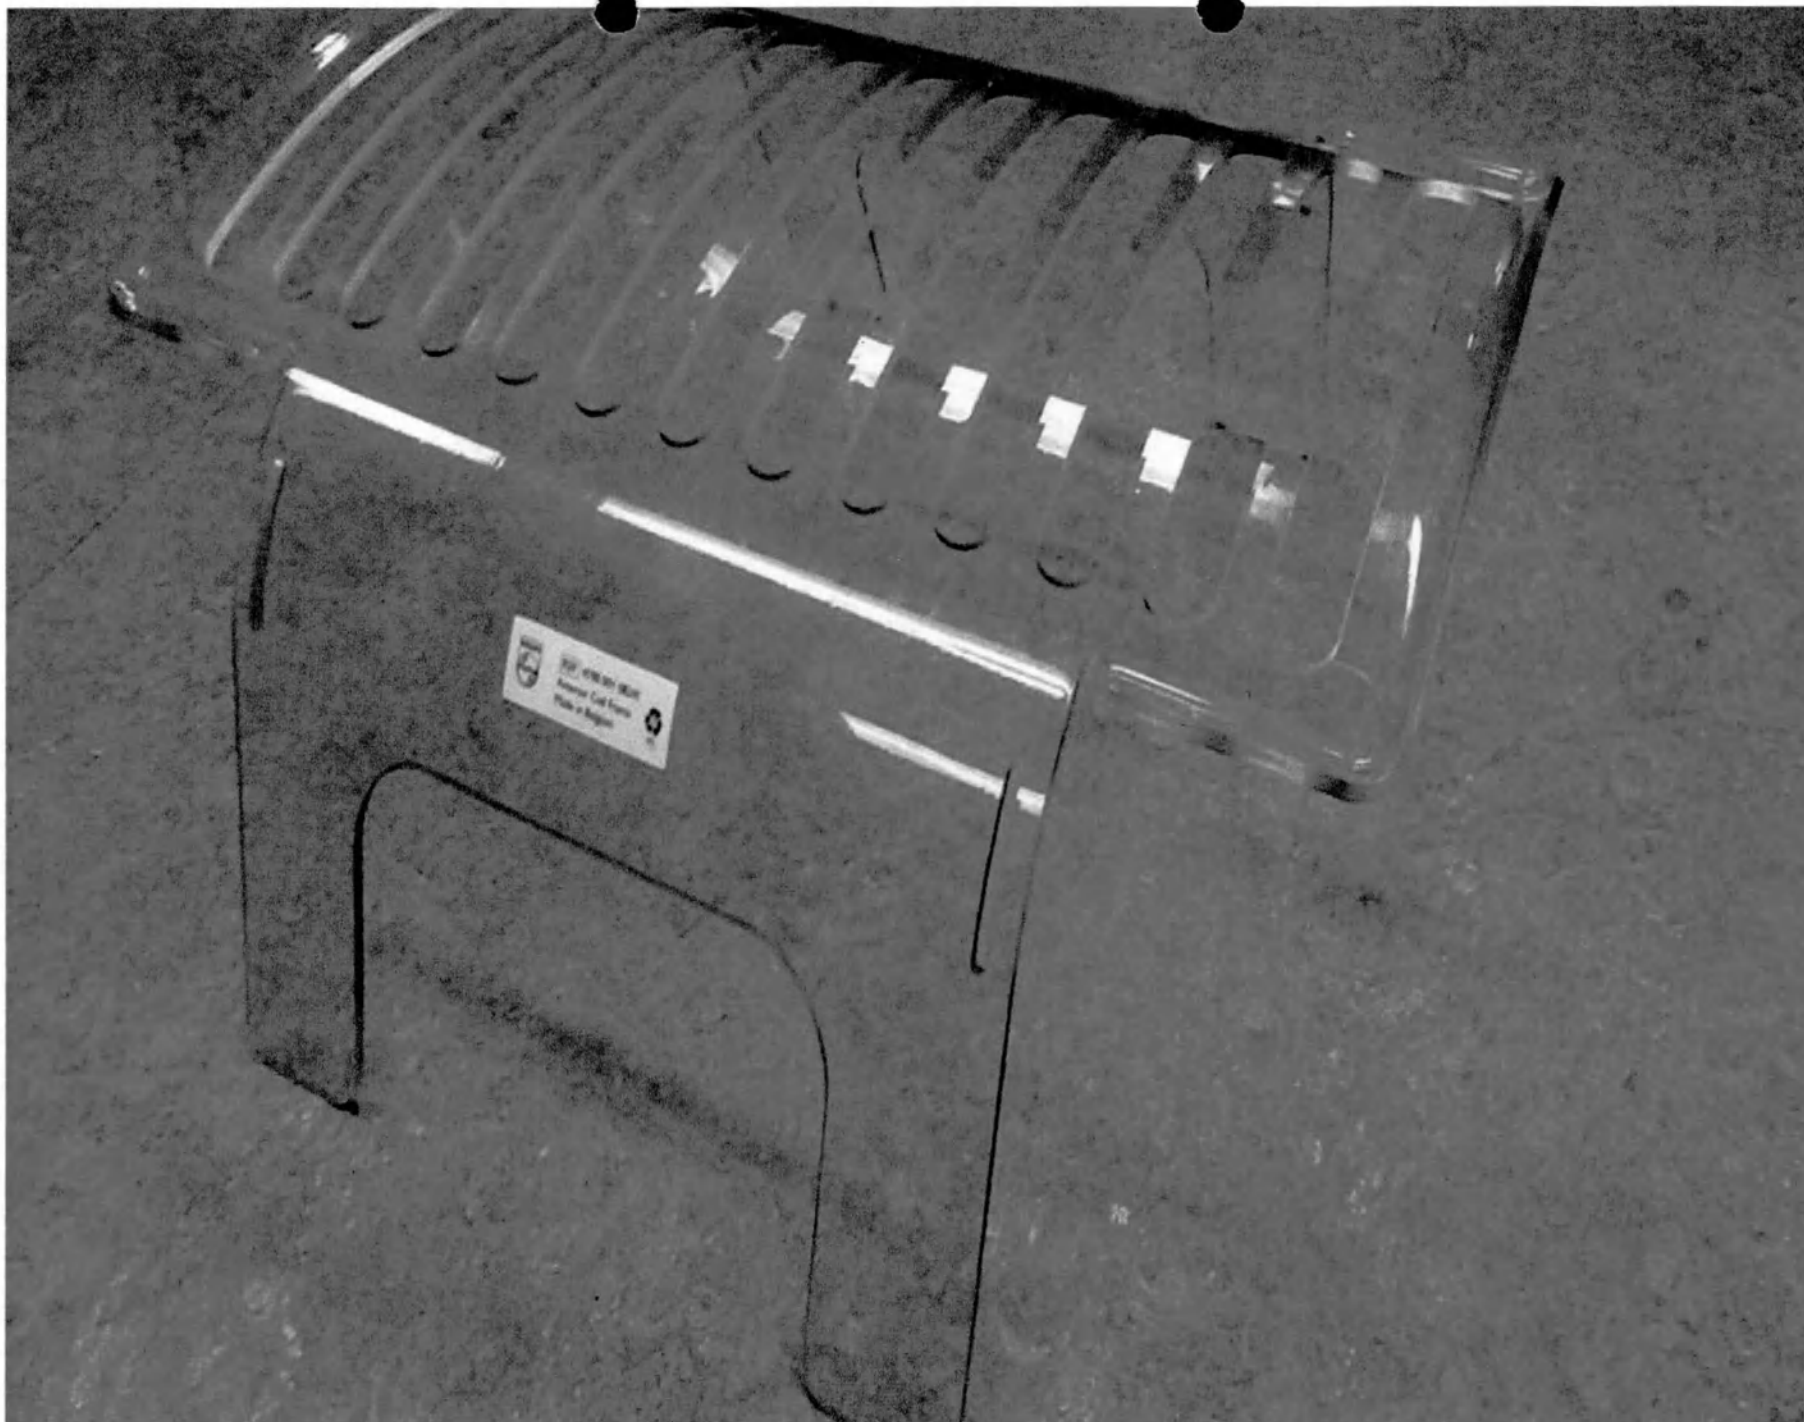

10.19.1 Опора для передней катушки.




10.19.2 Ремень для конечностей большого размера




10.20. Детская опора для колен.



10.21. Детский матрас для увеличения высоты.

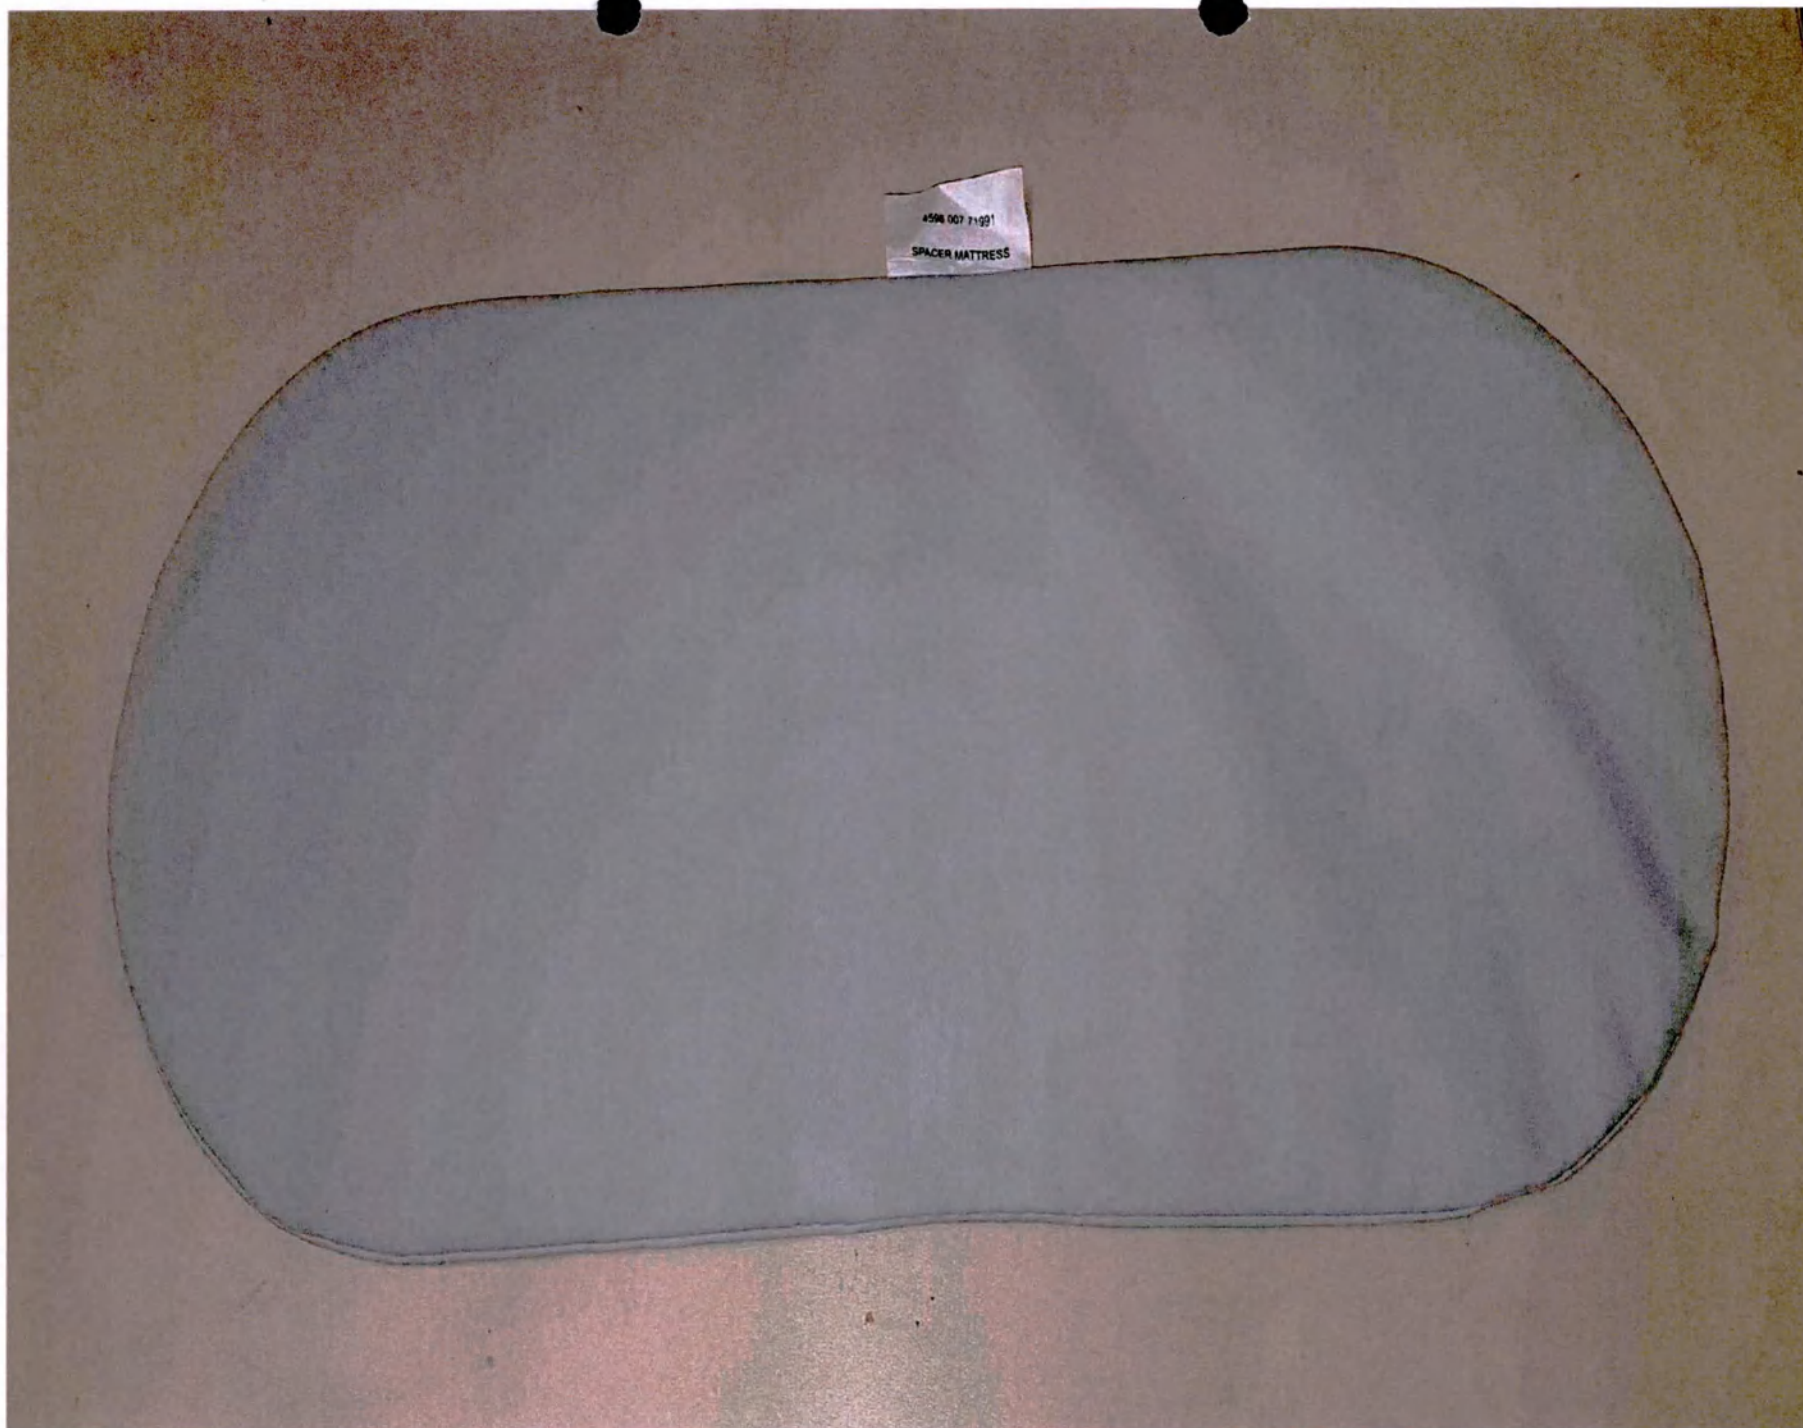


10.21. Прокладка для повышения комфорта.

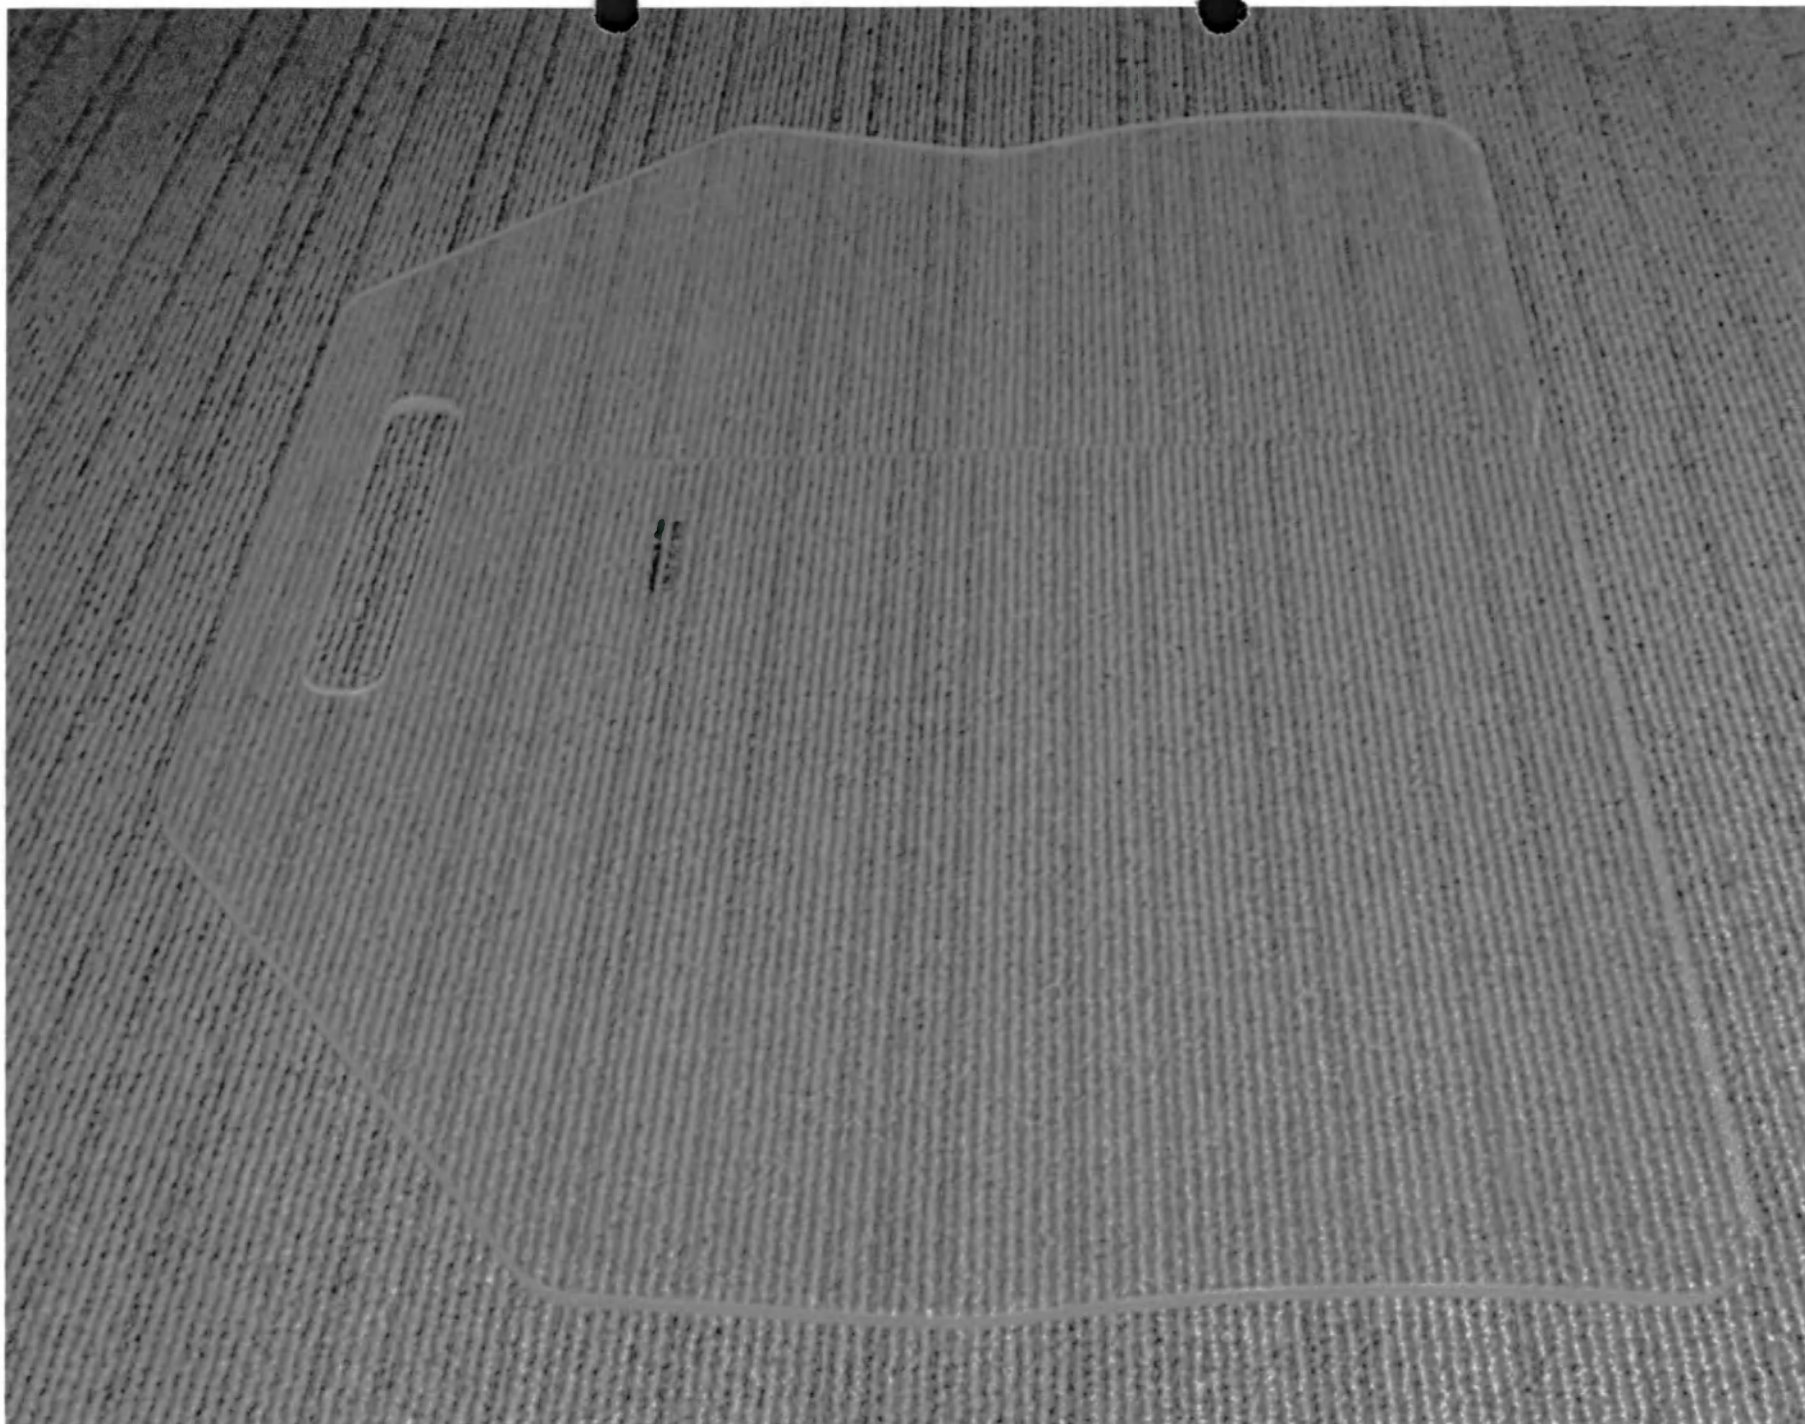

10.23. Опора для руки.



10.24. Фиксатор для ног.

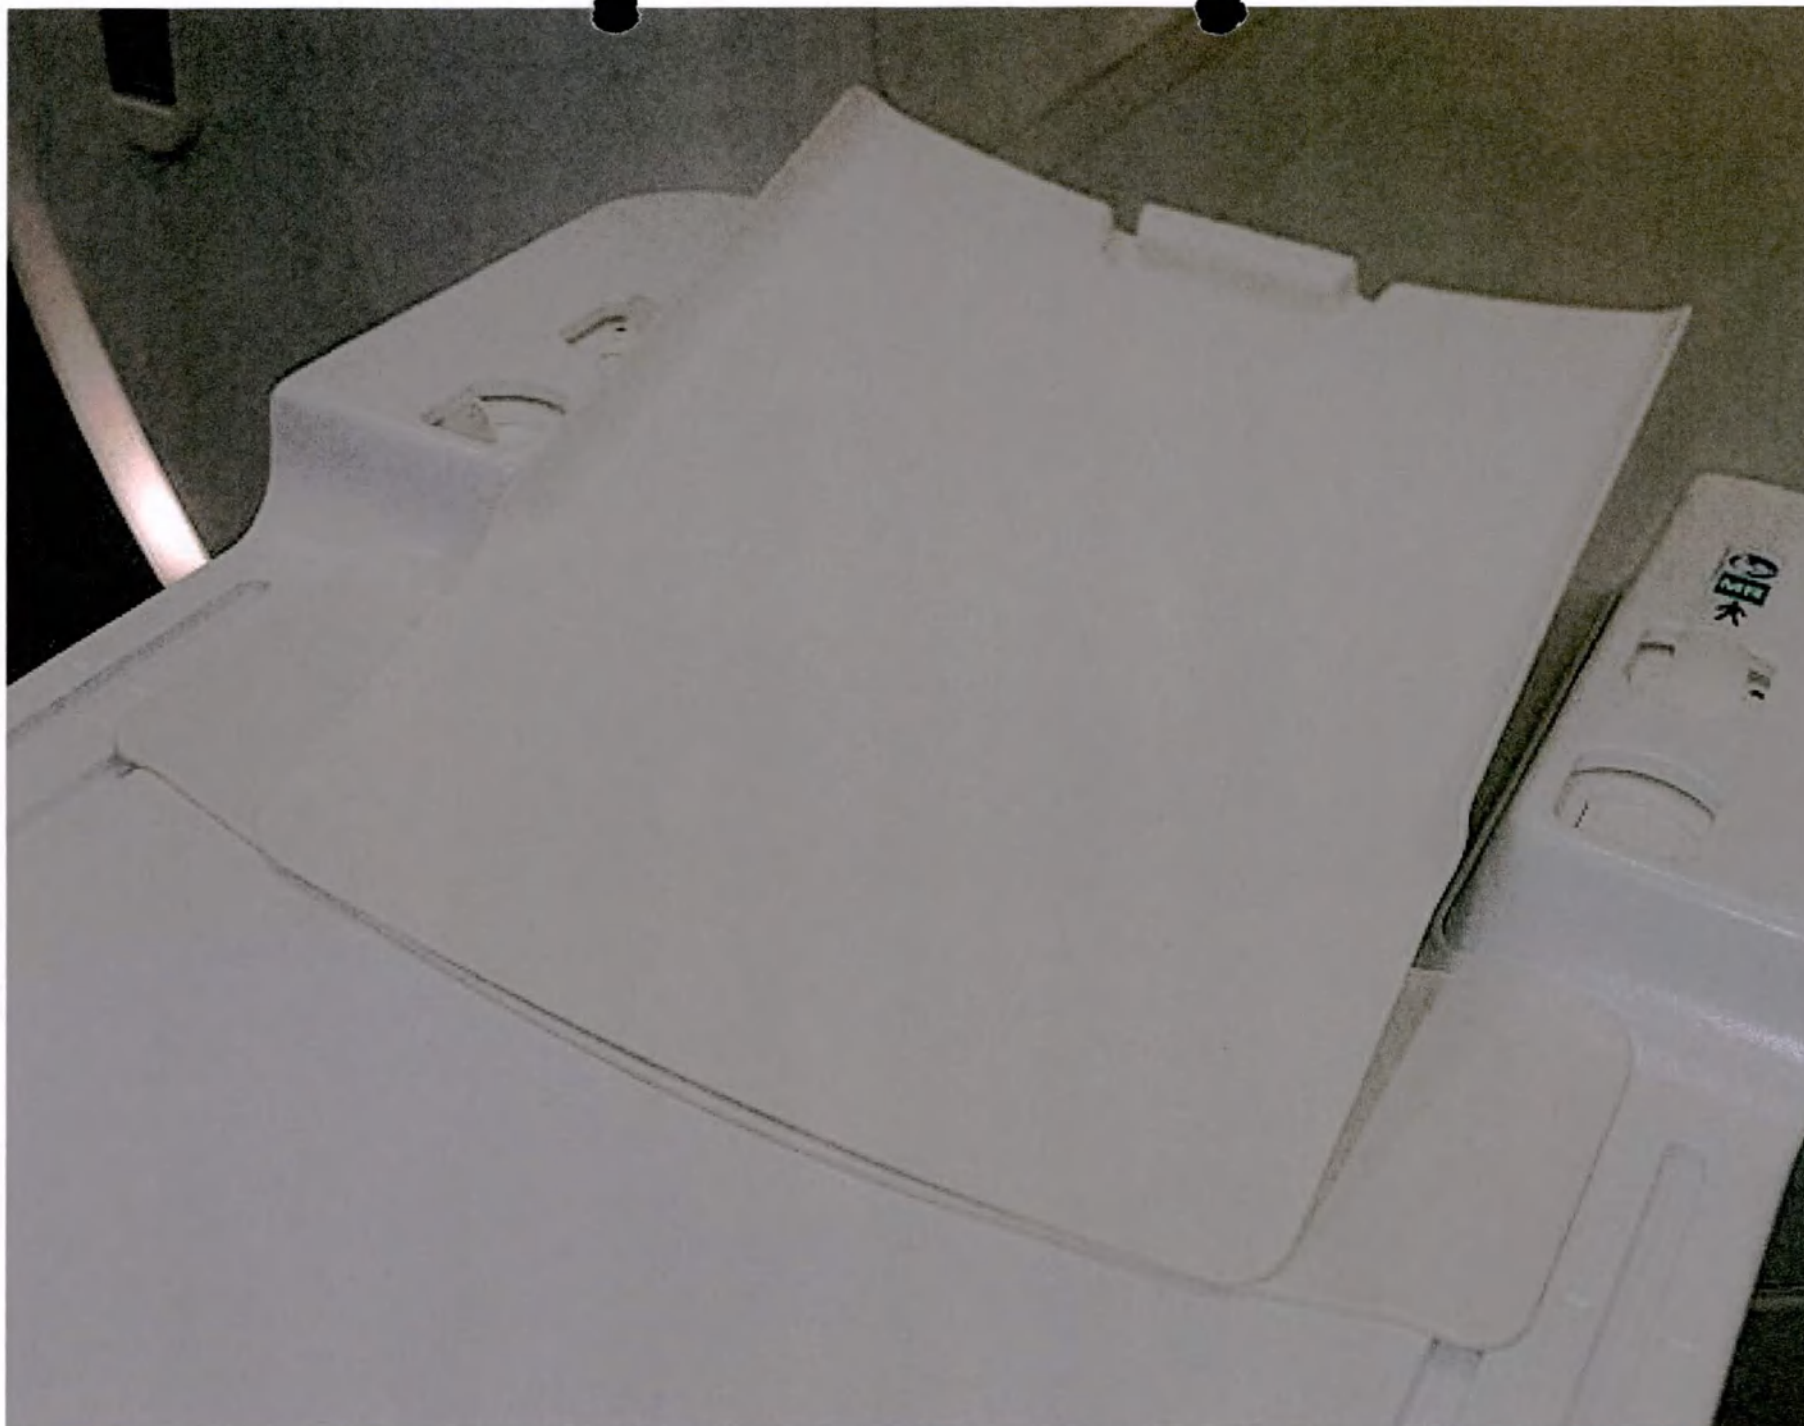

10.25. Устройство FlexTilt (Устройство для наклона).



10.26. Акустический шлем для детей.



10.27. Опора для головы и рук.




10.28. Опора для визуализации молочных желез.



11. Беспроводная система передачи физиологических данных, в составе:




11.1. Датчик дыхания.

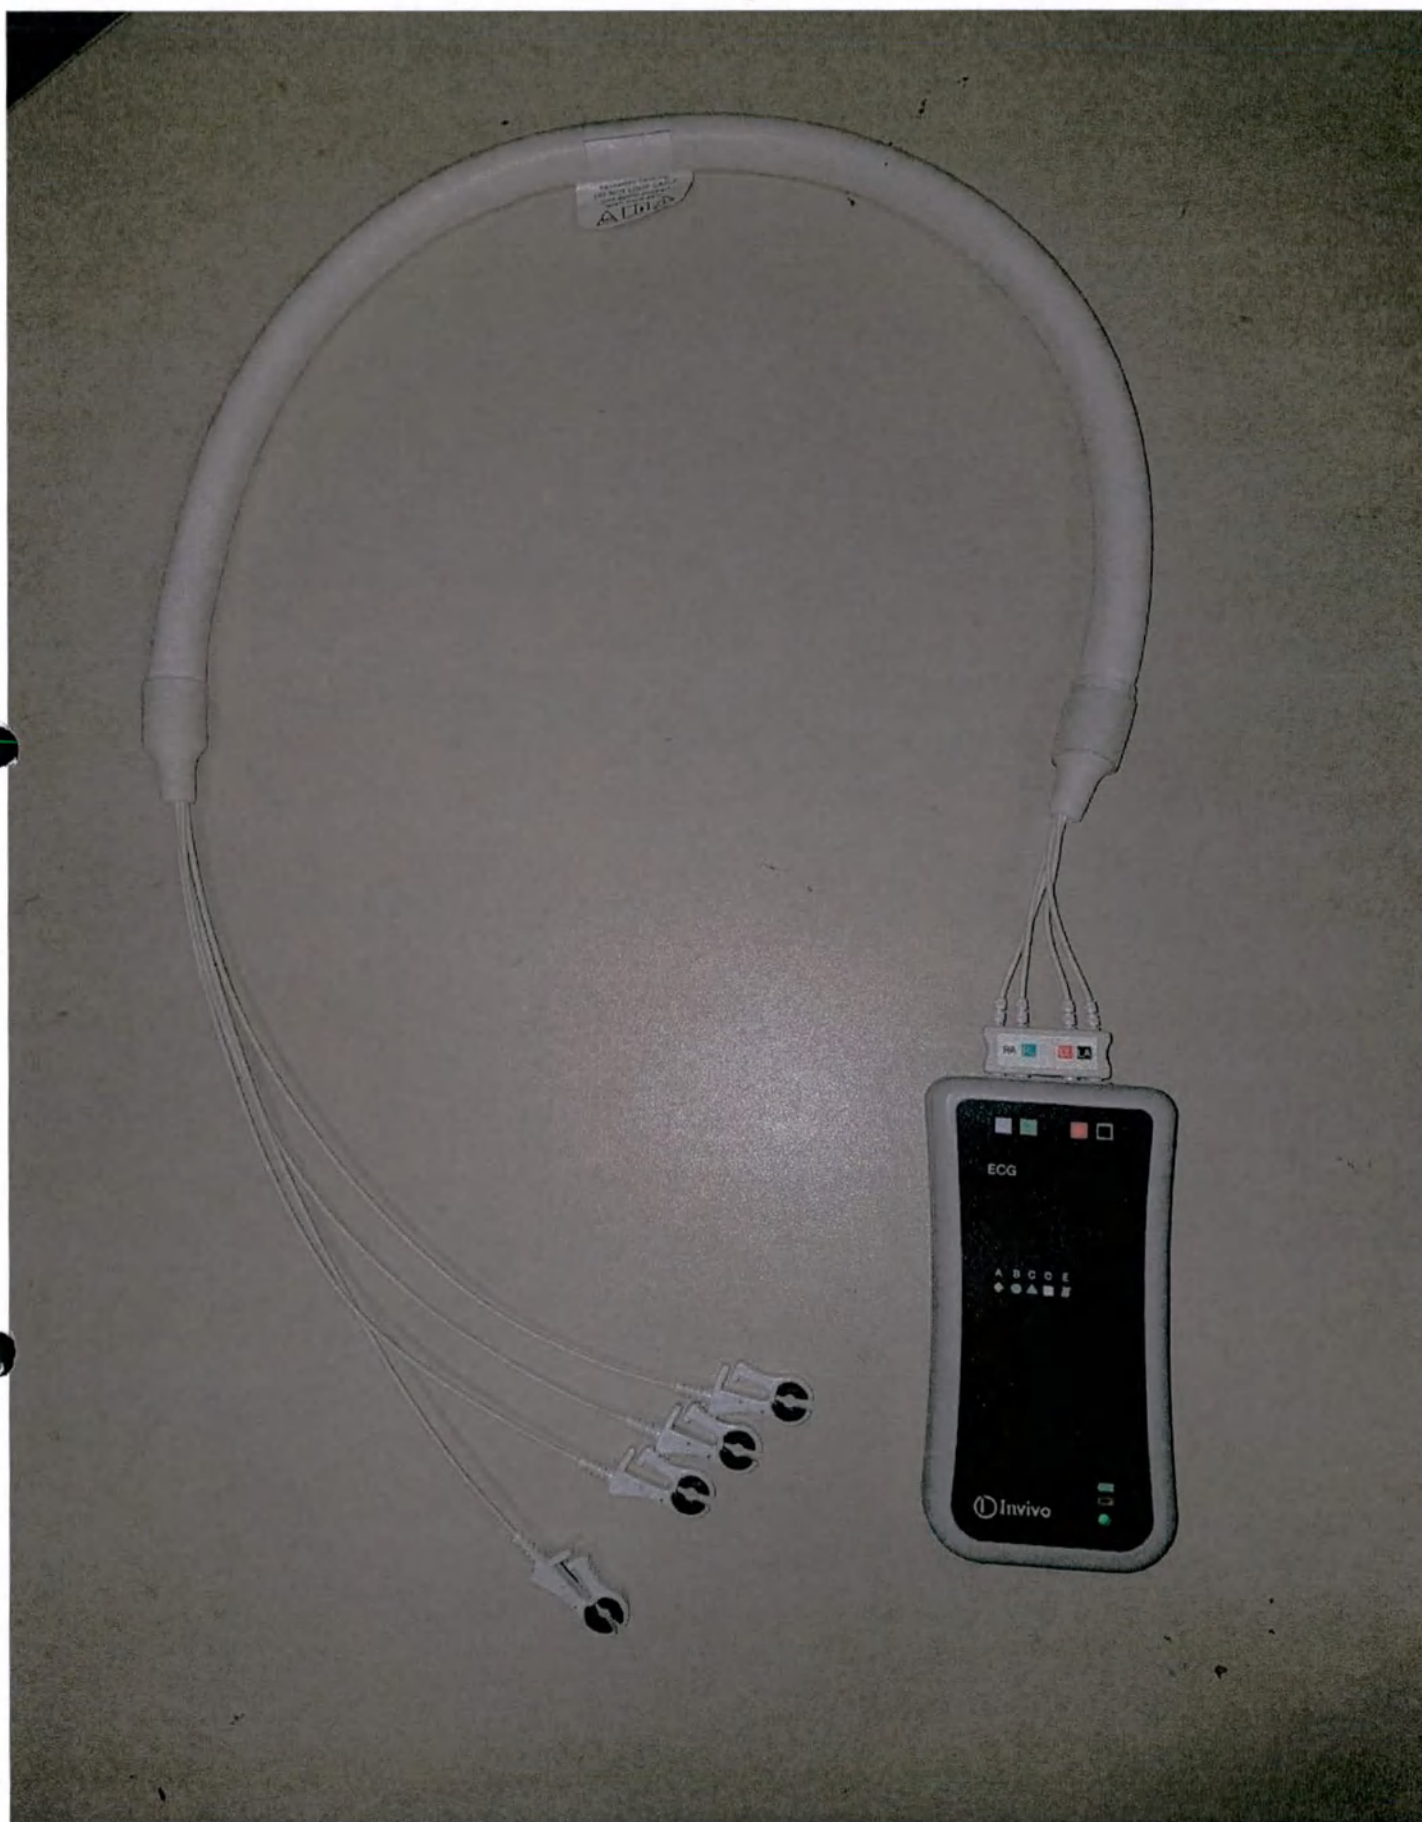

11.2. Беспроводной модуль ВКГ. Общий вид.




11.2. Беспроводной модуль ВКГ. Вид модуля вблизи.

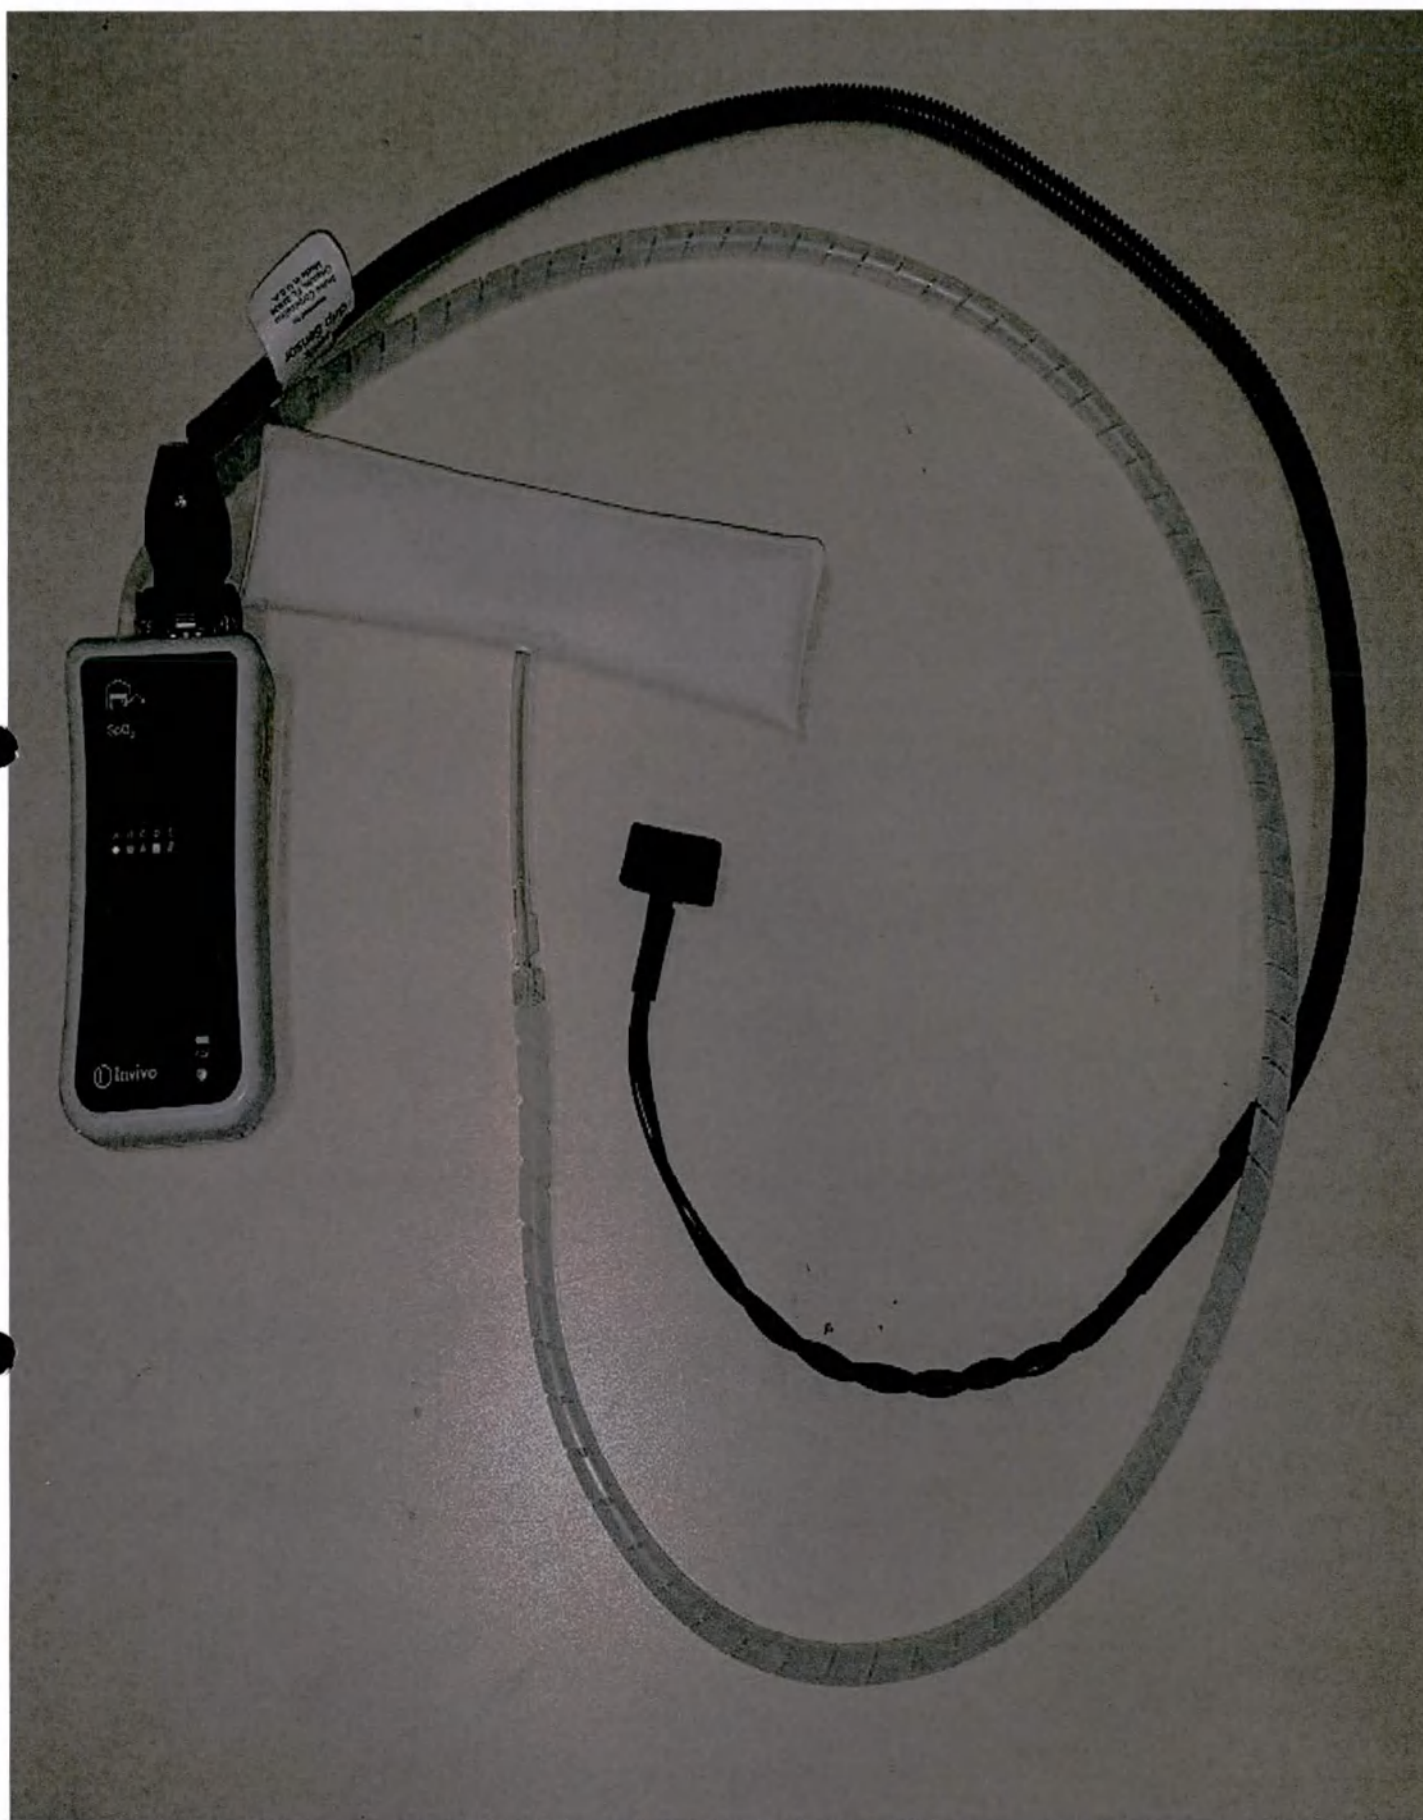


11.3. Беспроводной модуль PPU. Общий вид.



11.3. Беспроводной модуль PPU: Вид модуля вблизи.

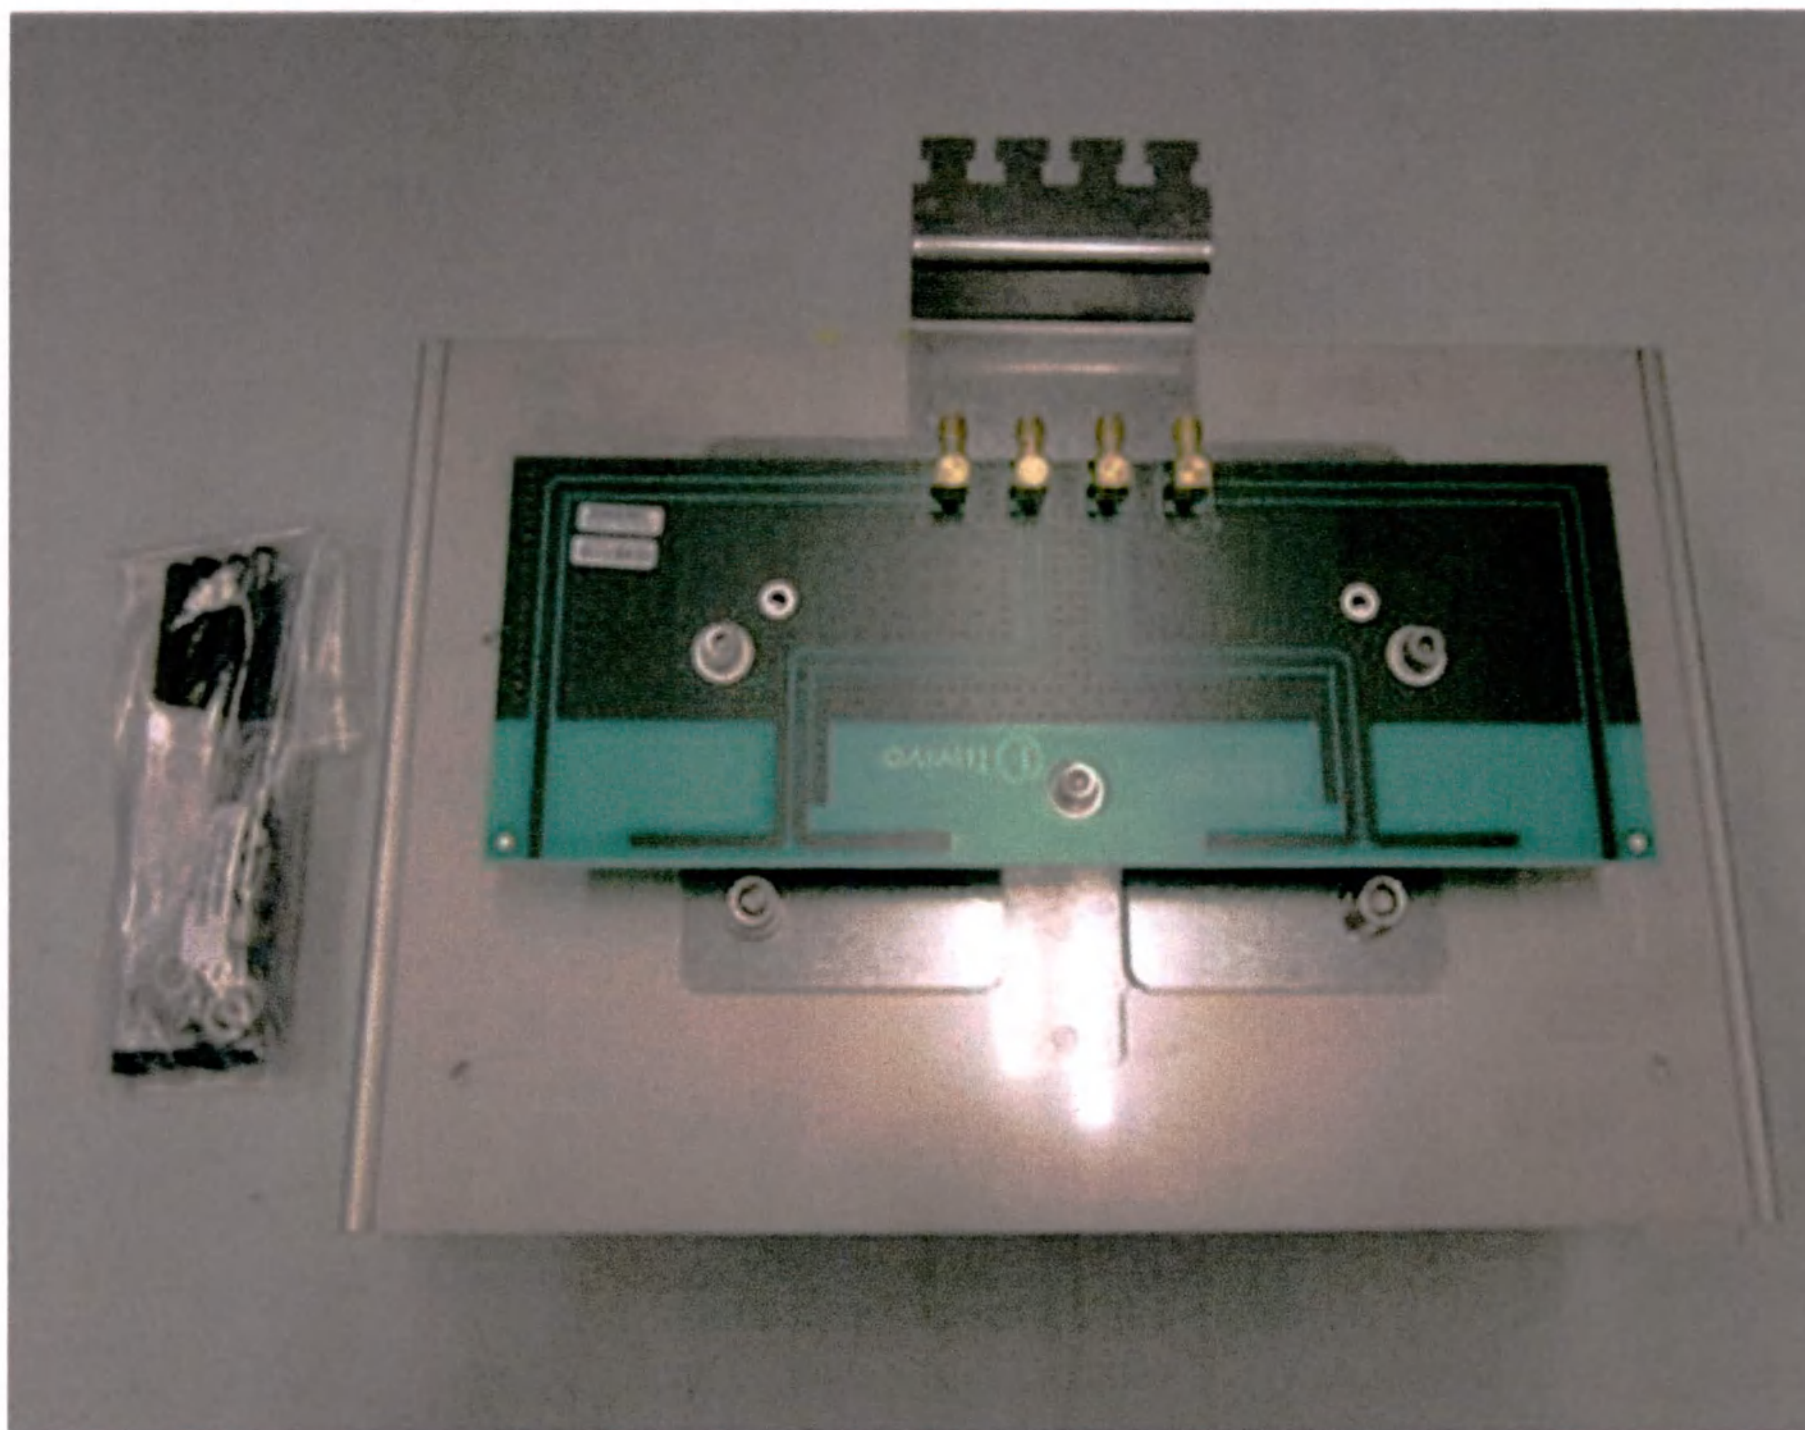

11.4. Беспроводной модуль базовой синхронизации.

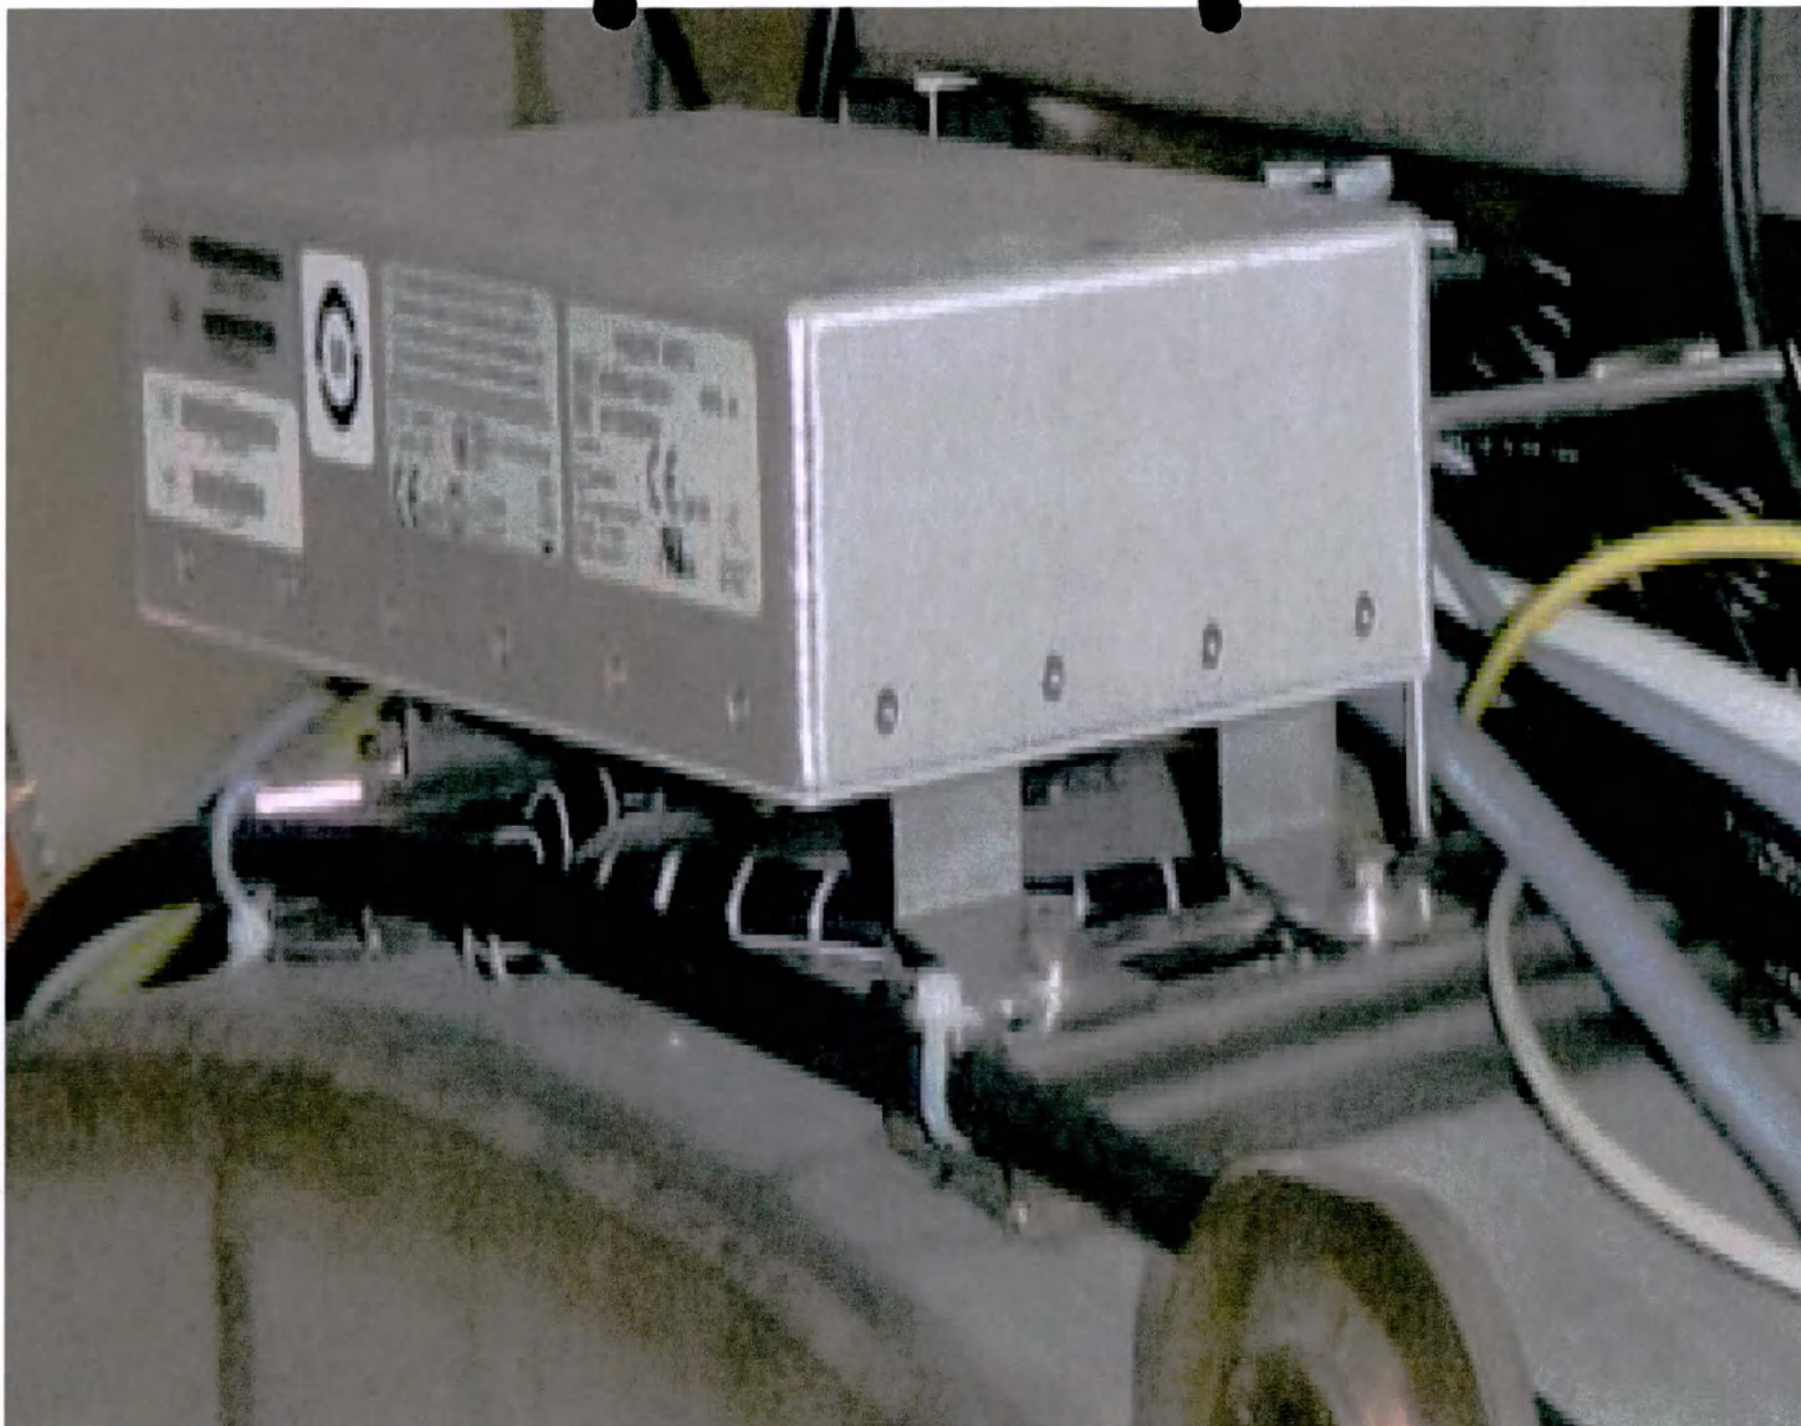


11.4. Беспроводной модуль базовой синхронизации.




11.5. Датчик периферического пульса SPO2.




11.6. Многоразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для детей.

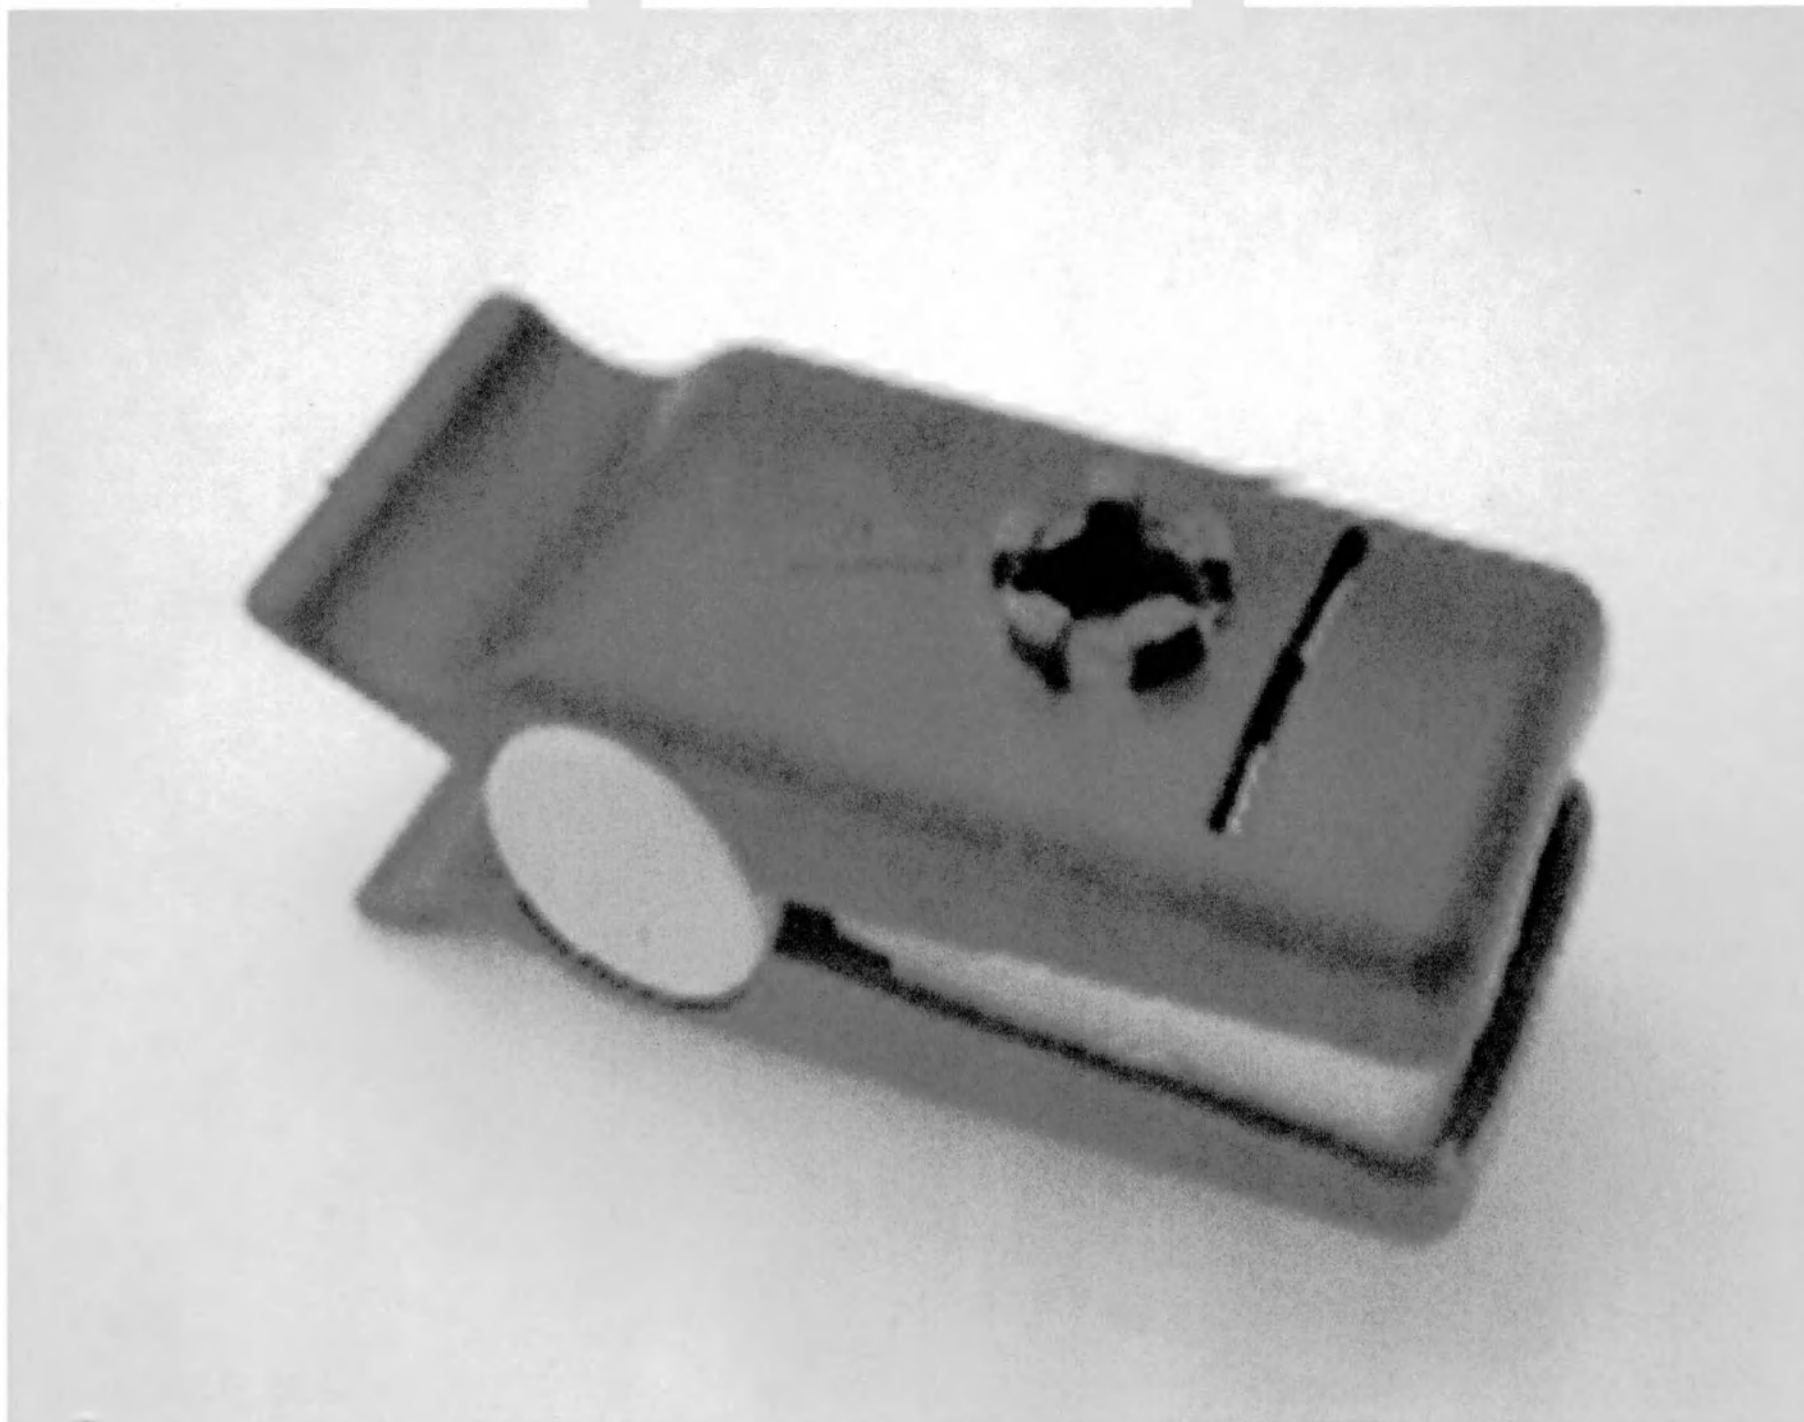


11.7. Многоразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для взрослых.

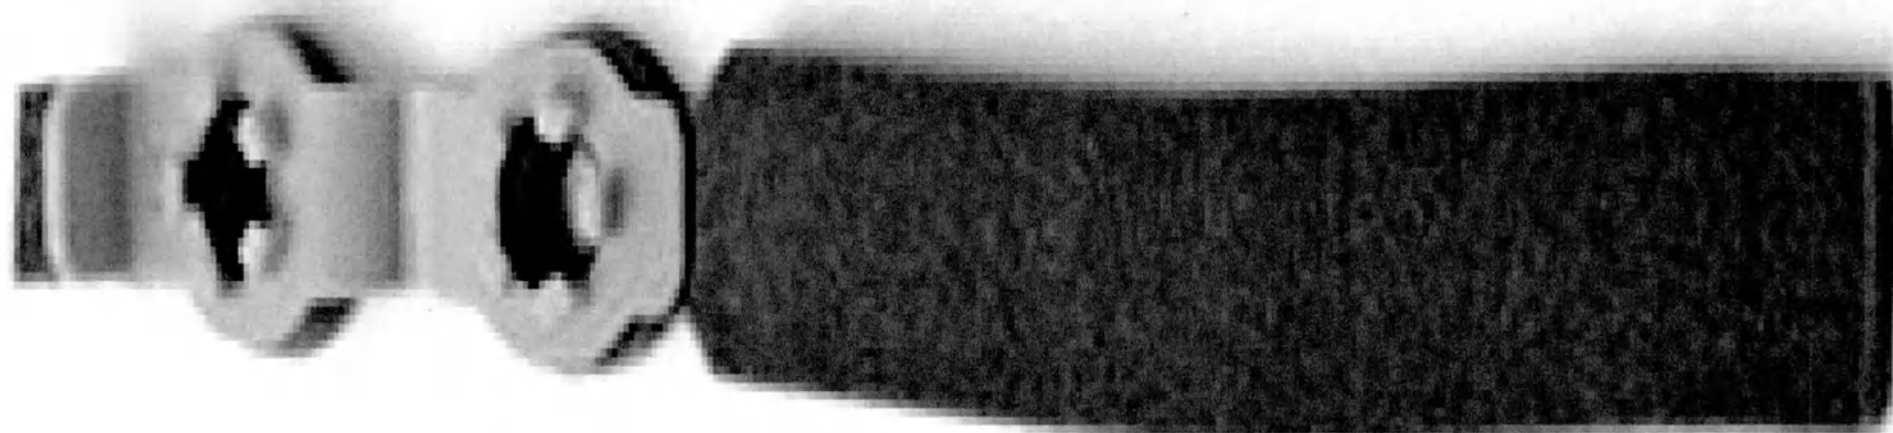

11.8. Одноразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для новорожденных.

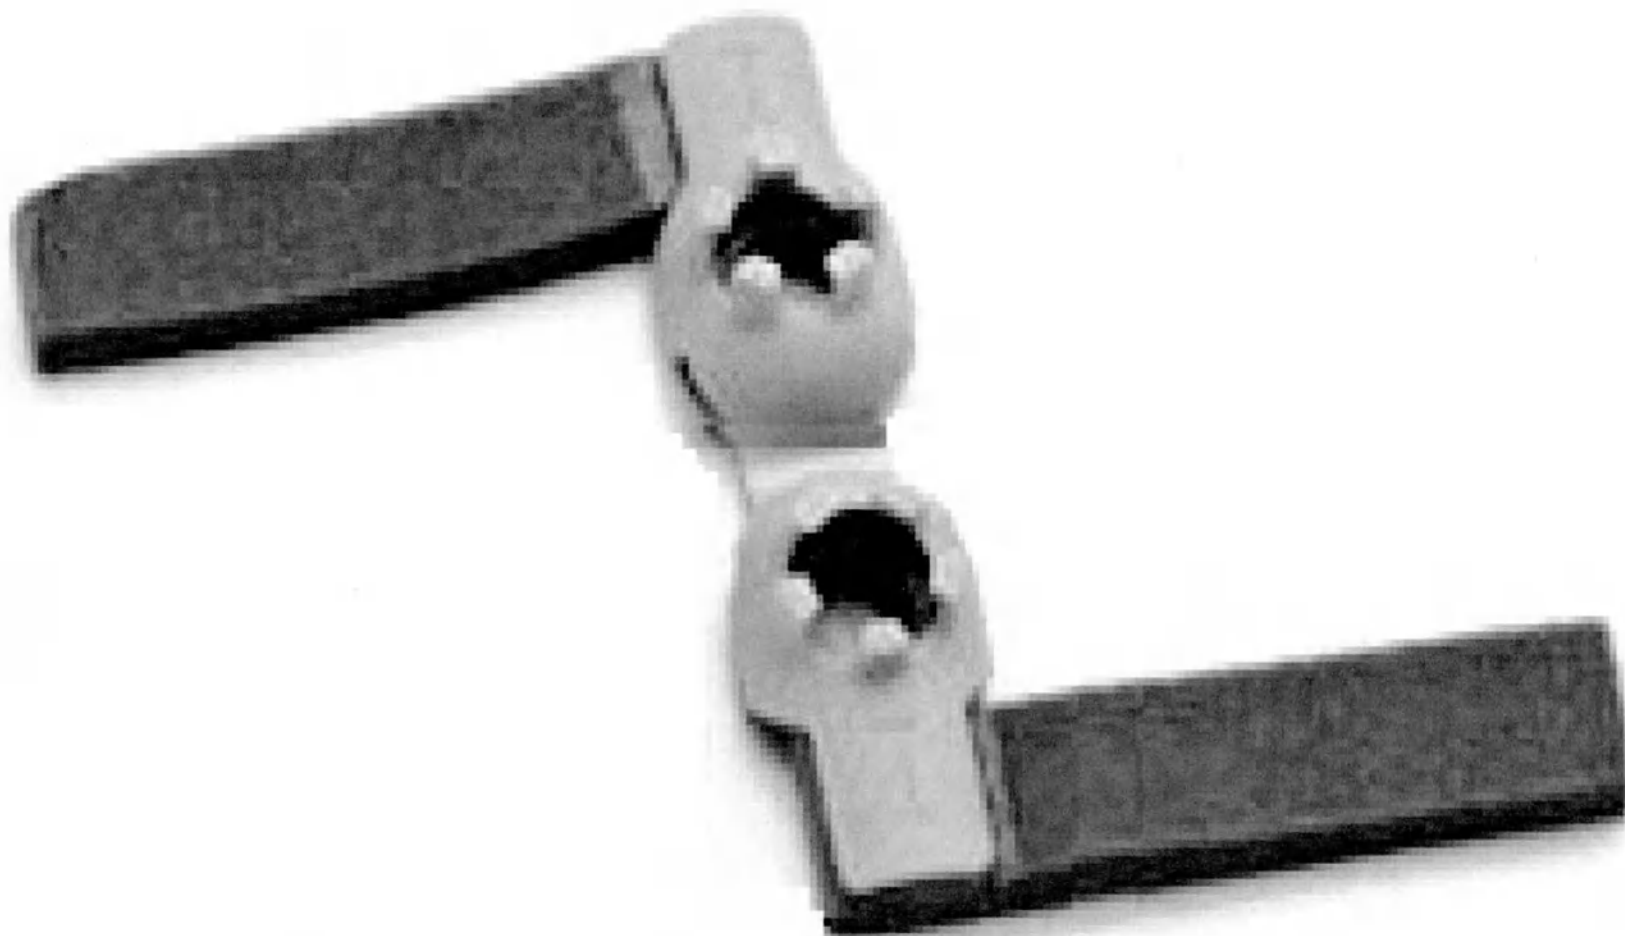

11.9. Одноразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для грудных детей.

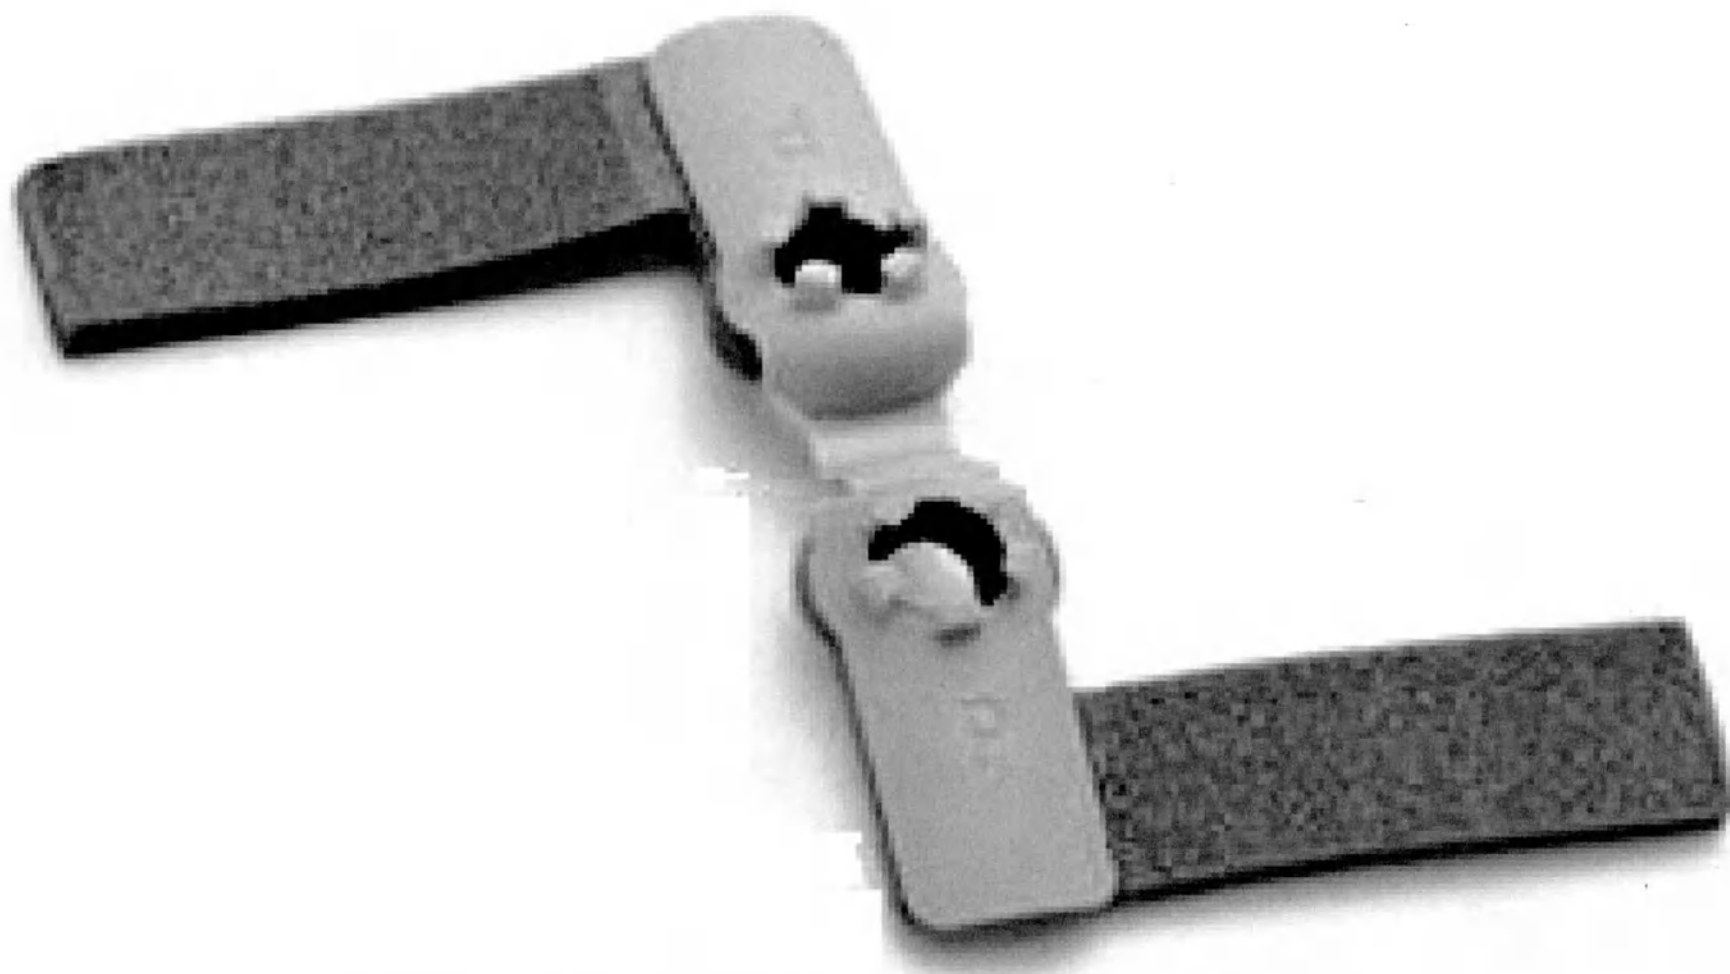

11.10. Одноразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для детей.



11.11. Одноразовый охватывающий зажим для датчика SPO2 для взрослых.

Assembled for  Made in USA 2016-01-15
Invivo, a division of Philips Medical Systems
12151 Research Parkway, Orlando, FL 32826 USA
REF 9065 Rev R **3.7V Rechargeable Li-Polymer**

CAUTION: Do not disassemble. Do not put in fire or short circuit. Only use specified manufacturer's charger. Replace with same **REF** only.


ATTENTION: Ne pas démonter la batterie. Ne pas provoquer de court-circuit sur la batterie et ne pas la jeter au feu. Utiliser uniquement le chargeur indiqué par le fabricant. Remplacer la batterie par le même numéro de référence uniquement.

SN M-177425 1ICP5/35/61 Watt-hour rating 3.1Wh

11.12. Аккумулятор для беспроводных модулей.



11.13. Зарядное устройство.

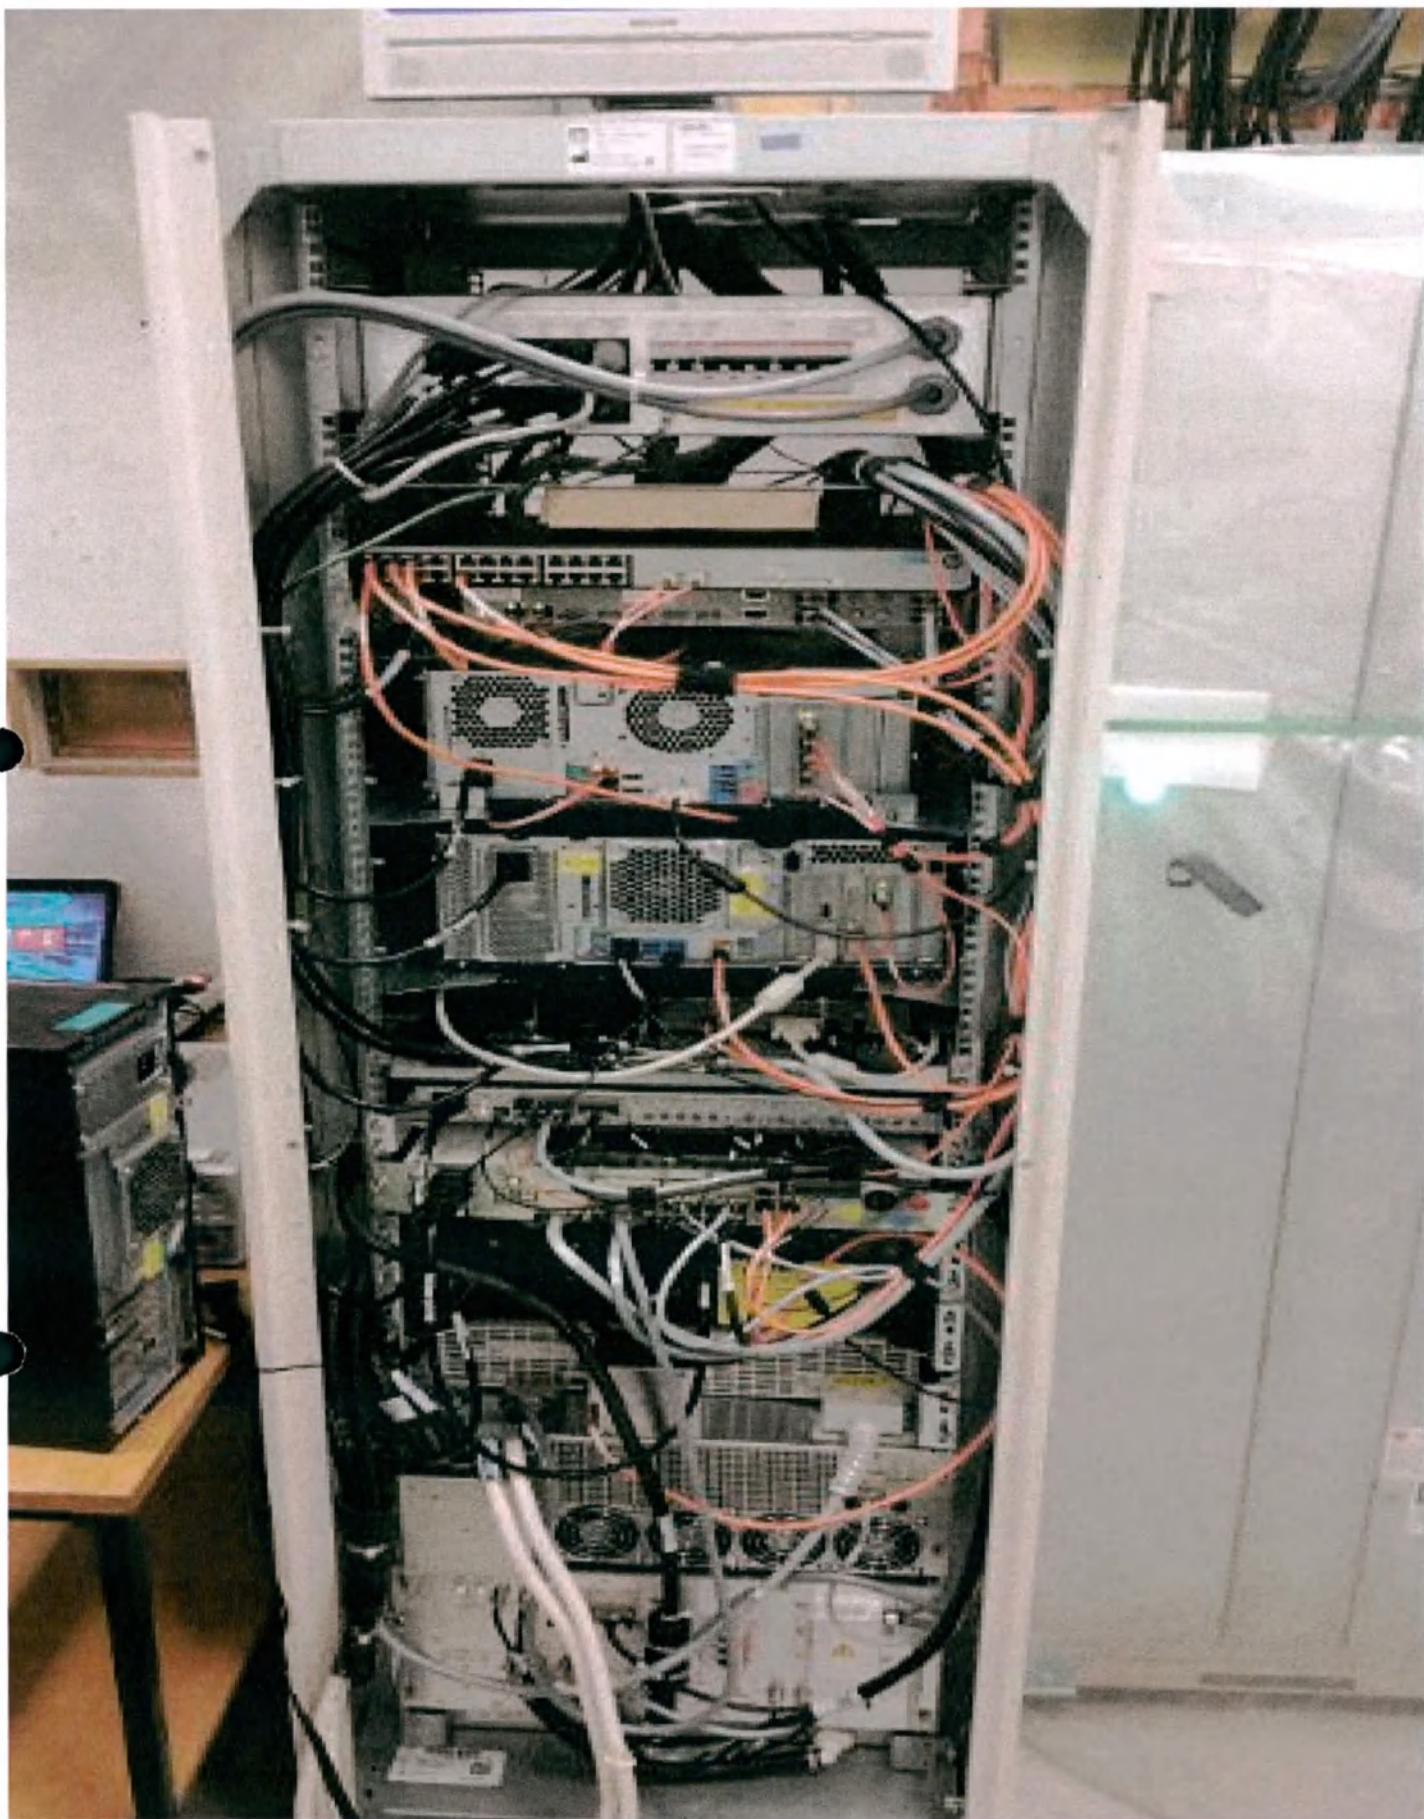

12. Система сбора и управления данными DACC.




13. Кнопка экстренной остановки магнита. Вид в упаковке.




13. Кнопка экстренной остановки магнита.



14. Кожух магнита (вид спереди).

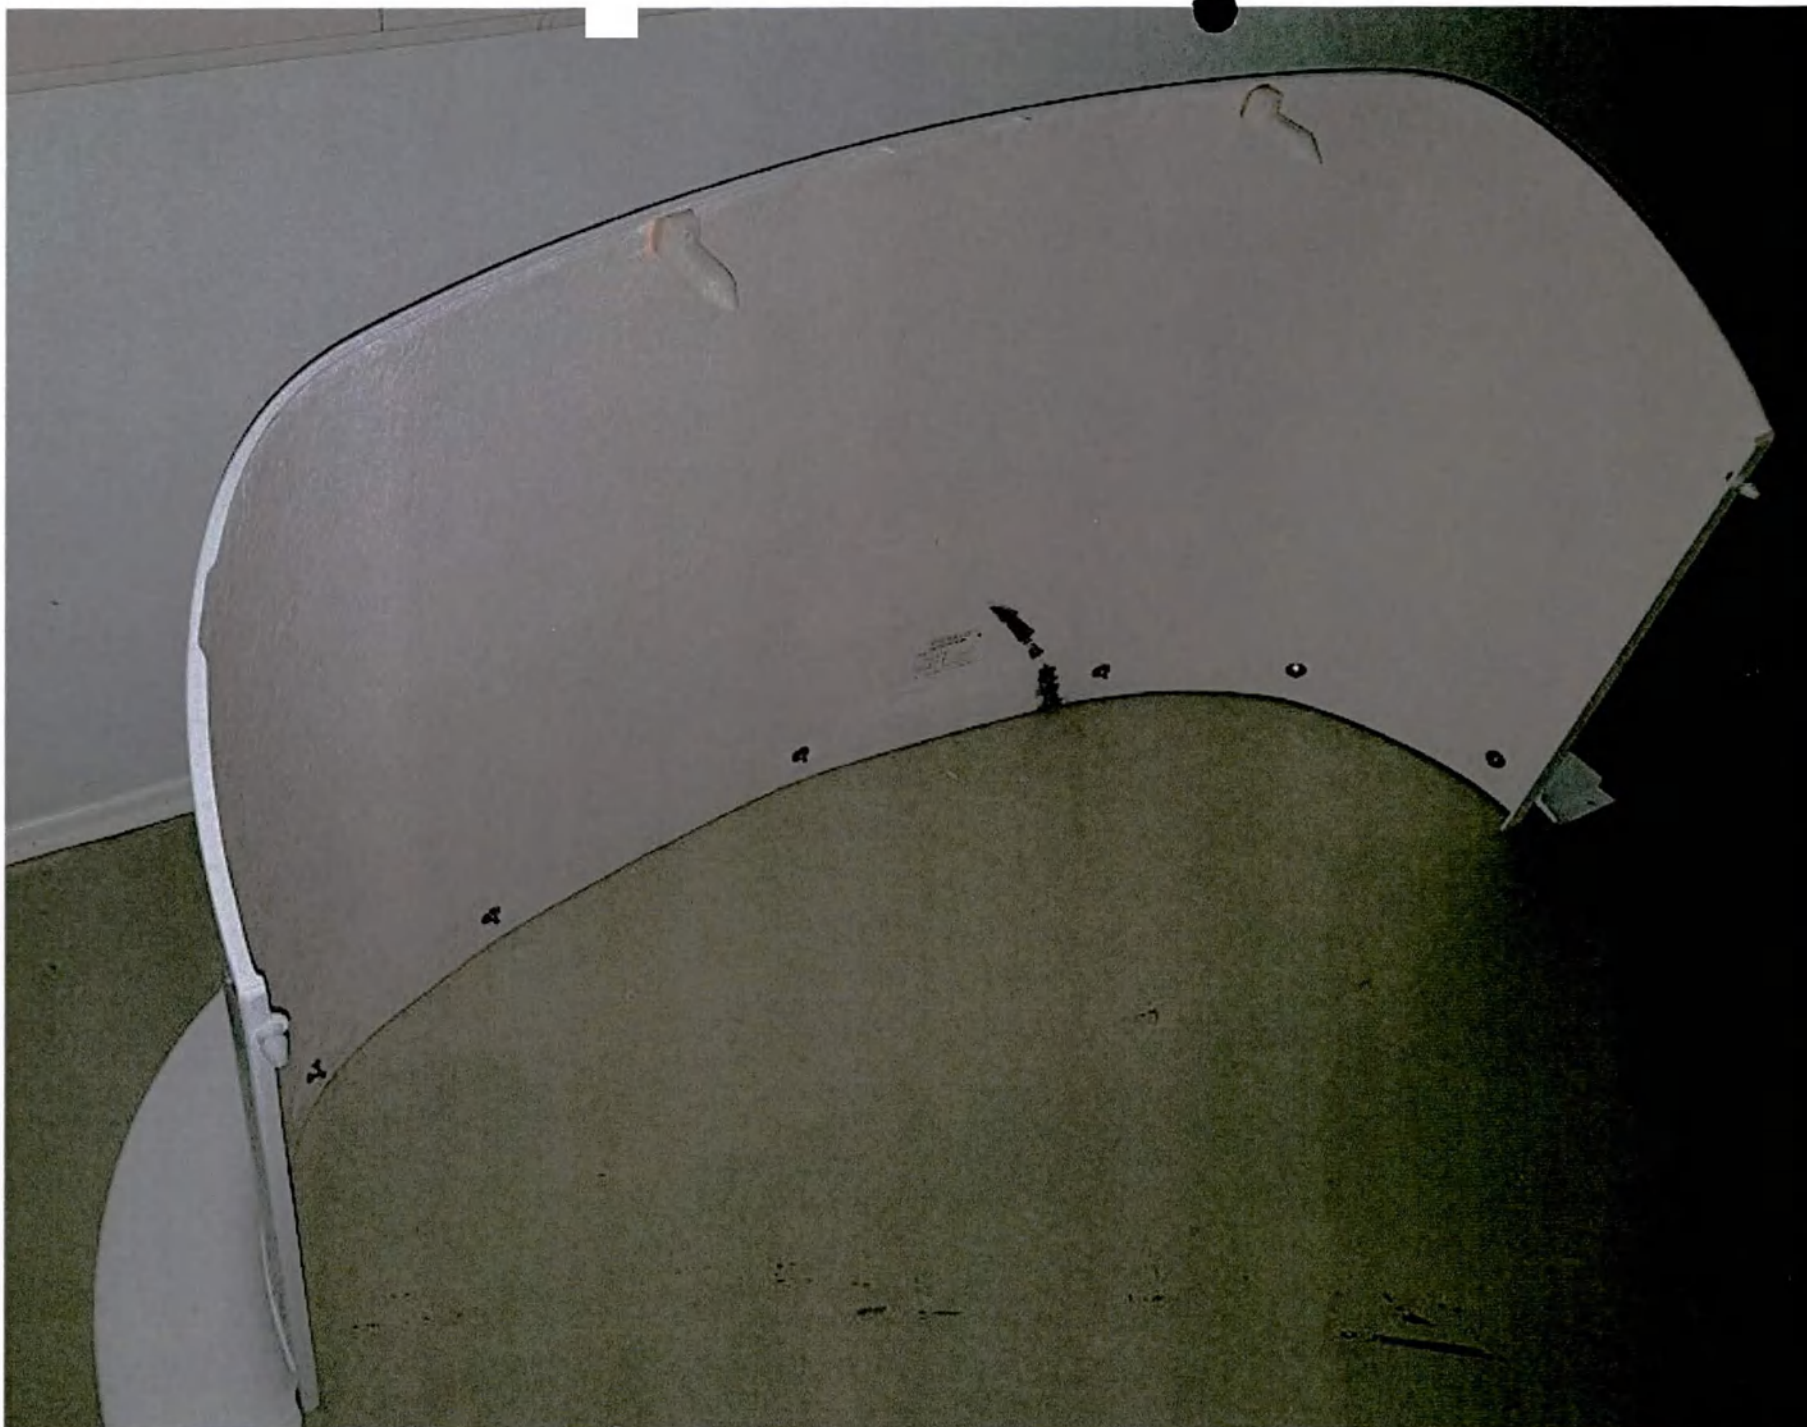

14. Кожух магнита (вид изнутри).

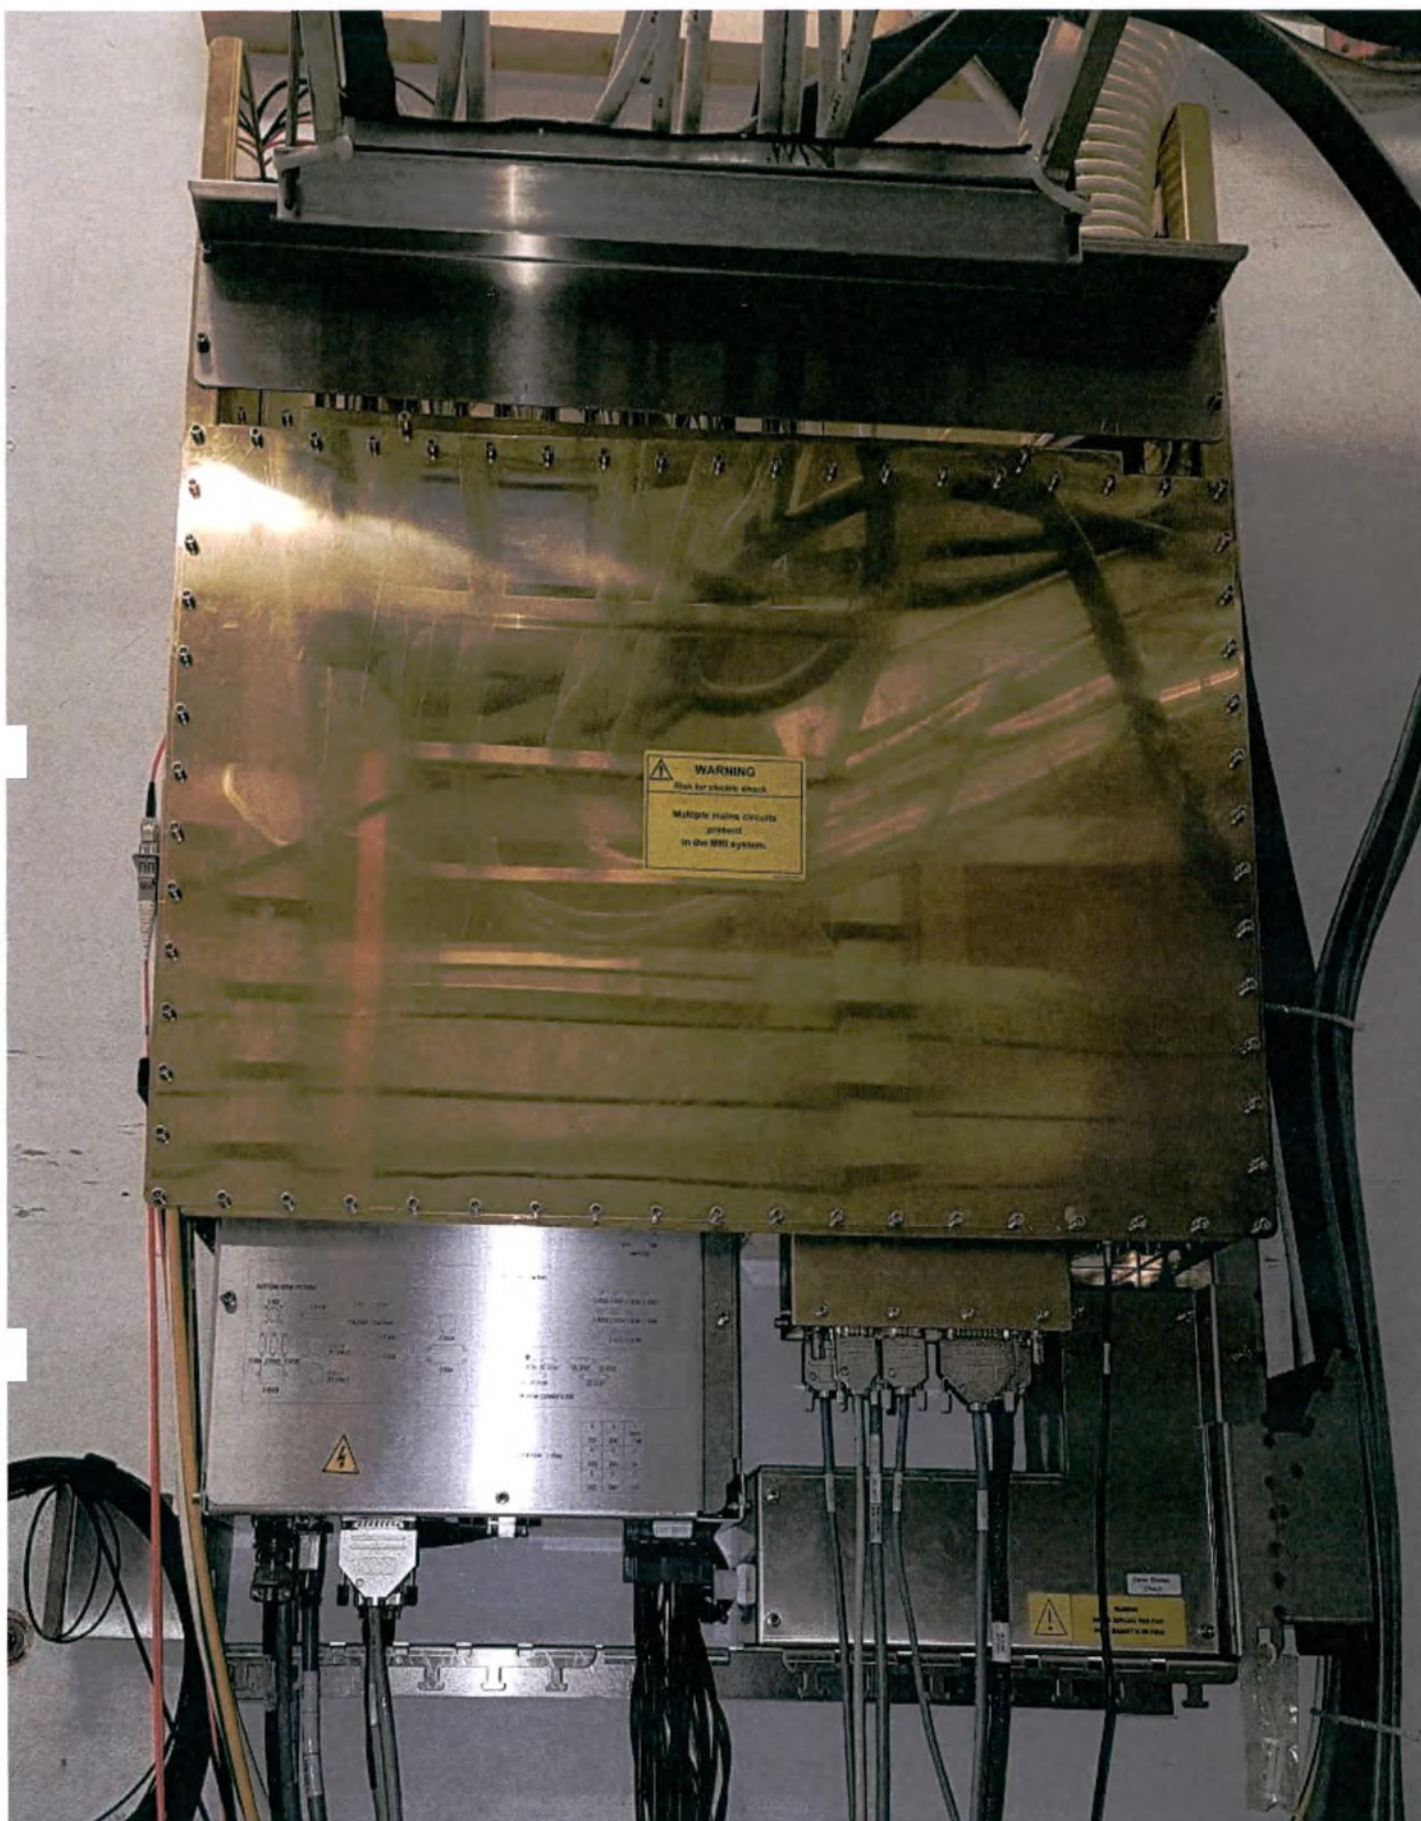

15. Системный фильтрующий блок.



16. Система охлаждения.



17.1. Низкотемпературный компрессор F-40.




17.2. Низкотемпературный компрессор F-70.



17.3. Низкотемпературный компрессор FA-40.



17.4. Низкотемпературный компрессор F-70HWA.

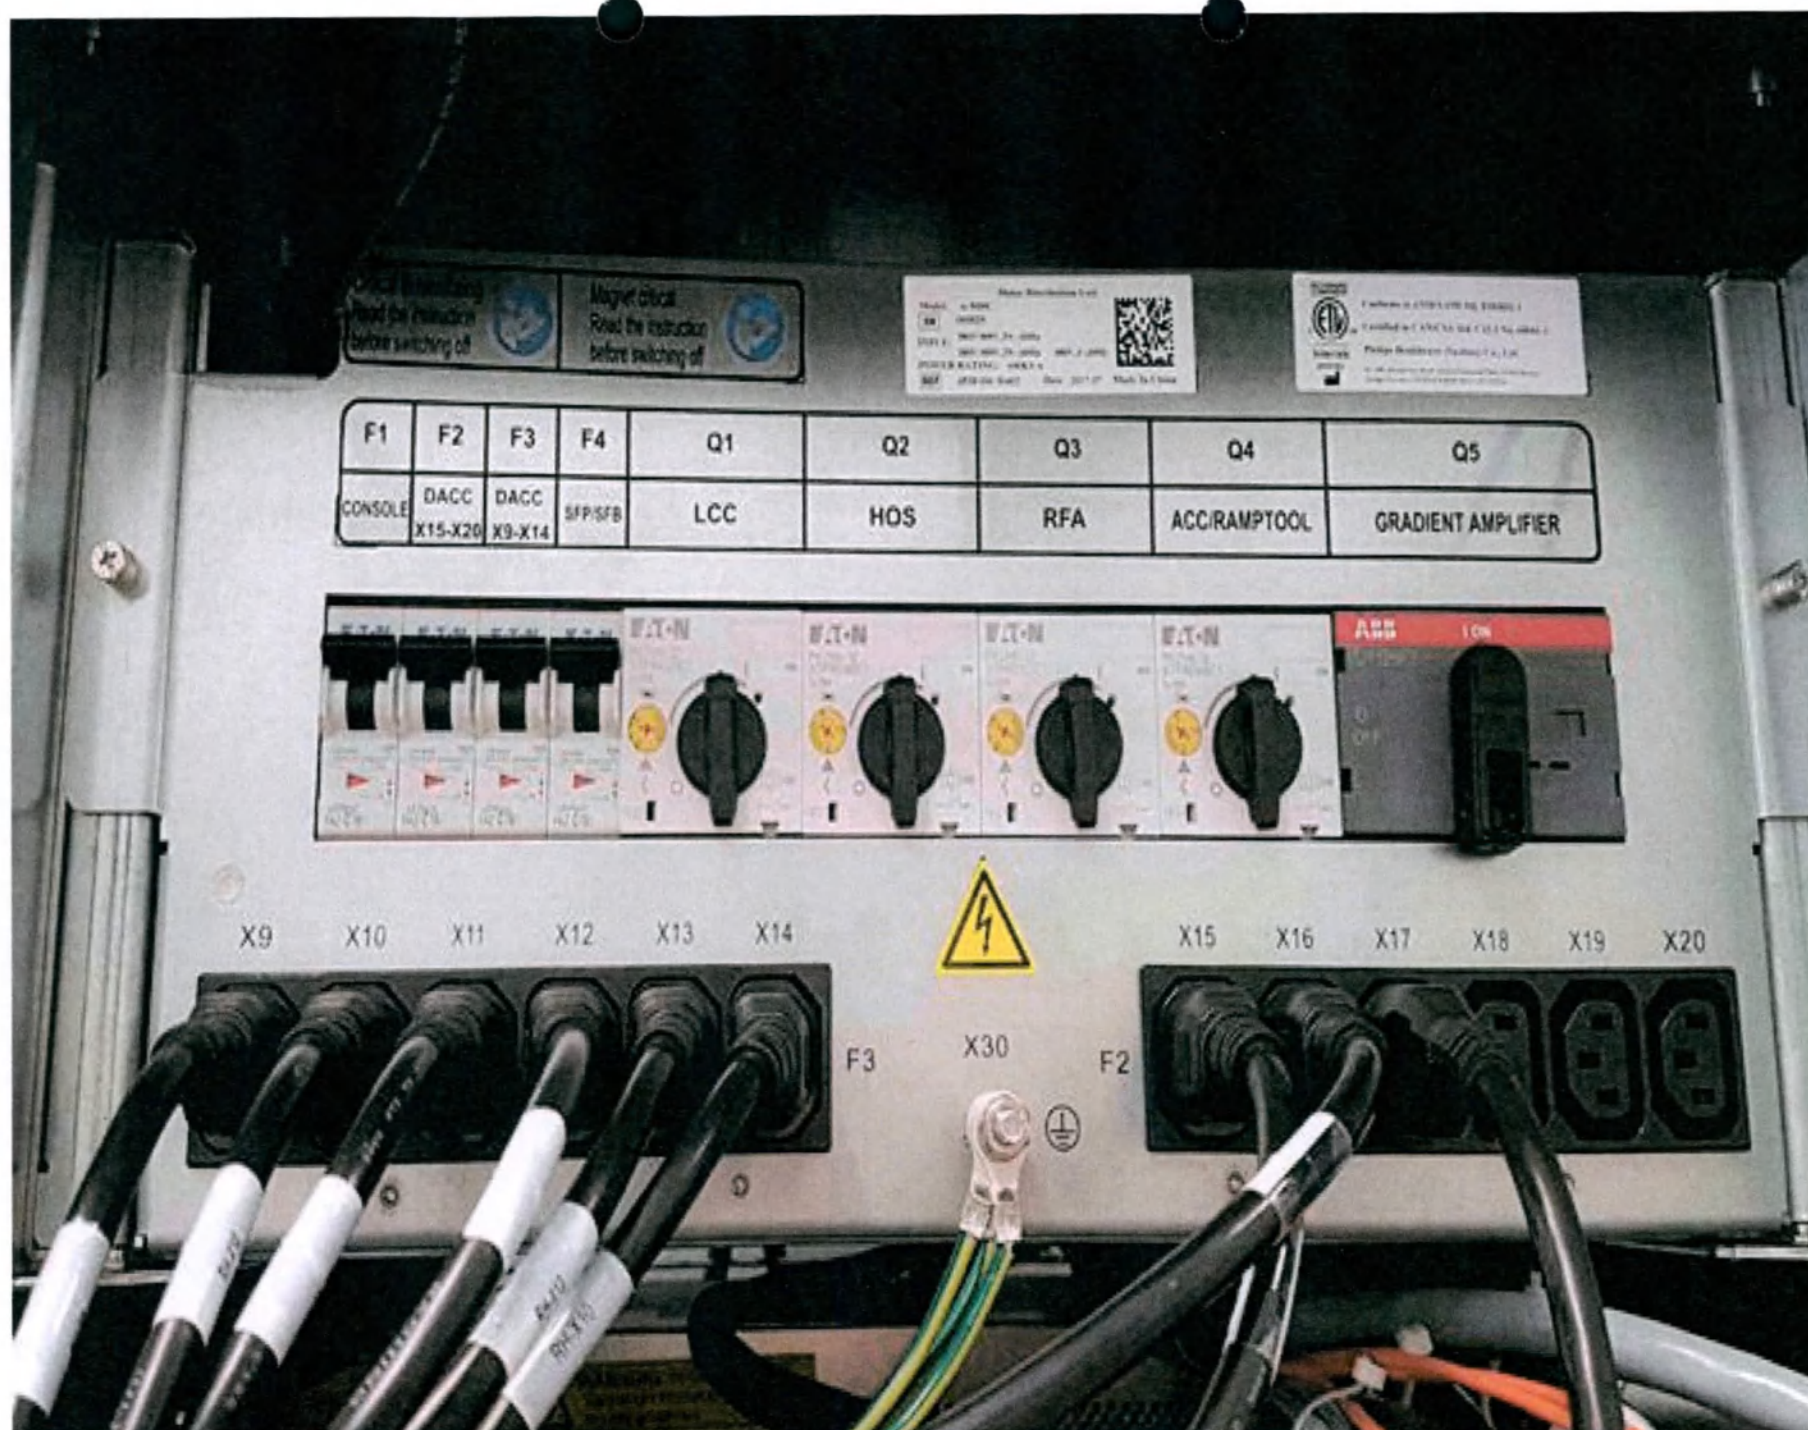


18. Универсальный электрораспределительный щит uMDU.



19. Источник бесперебойного питания.




20. Портативный металлодетектор.

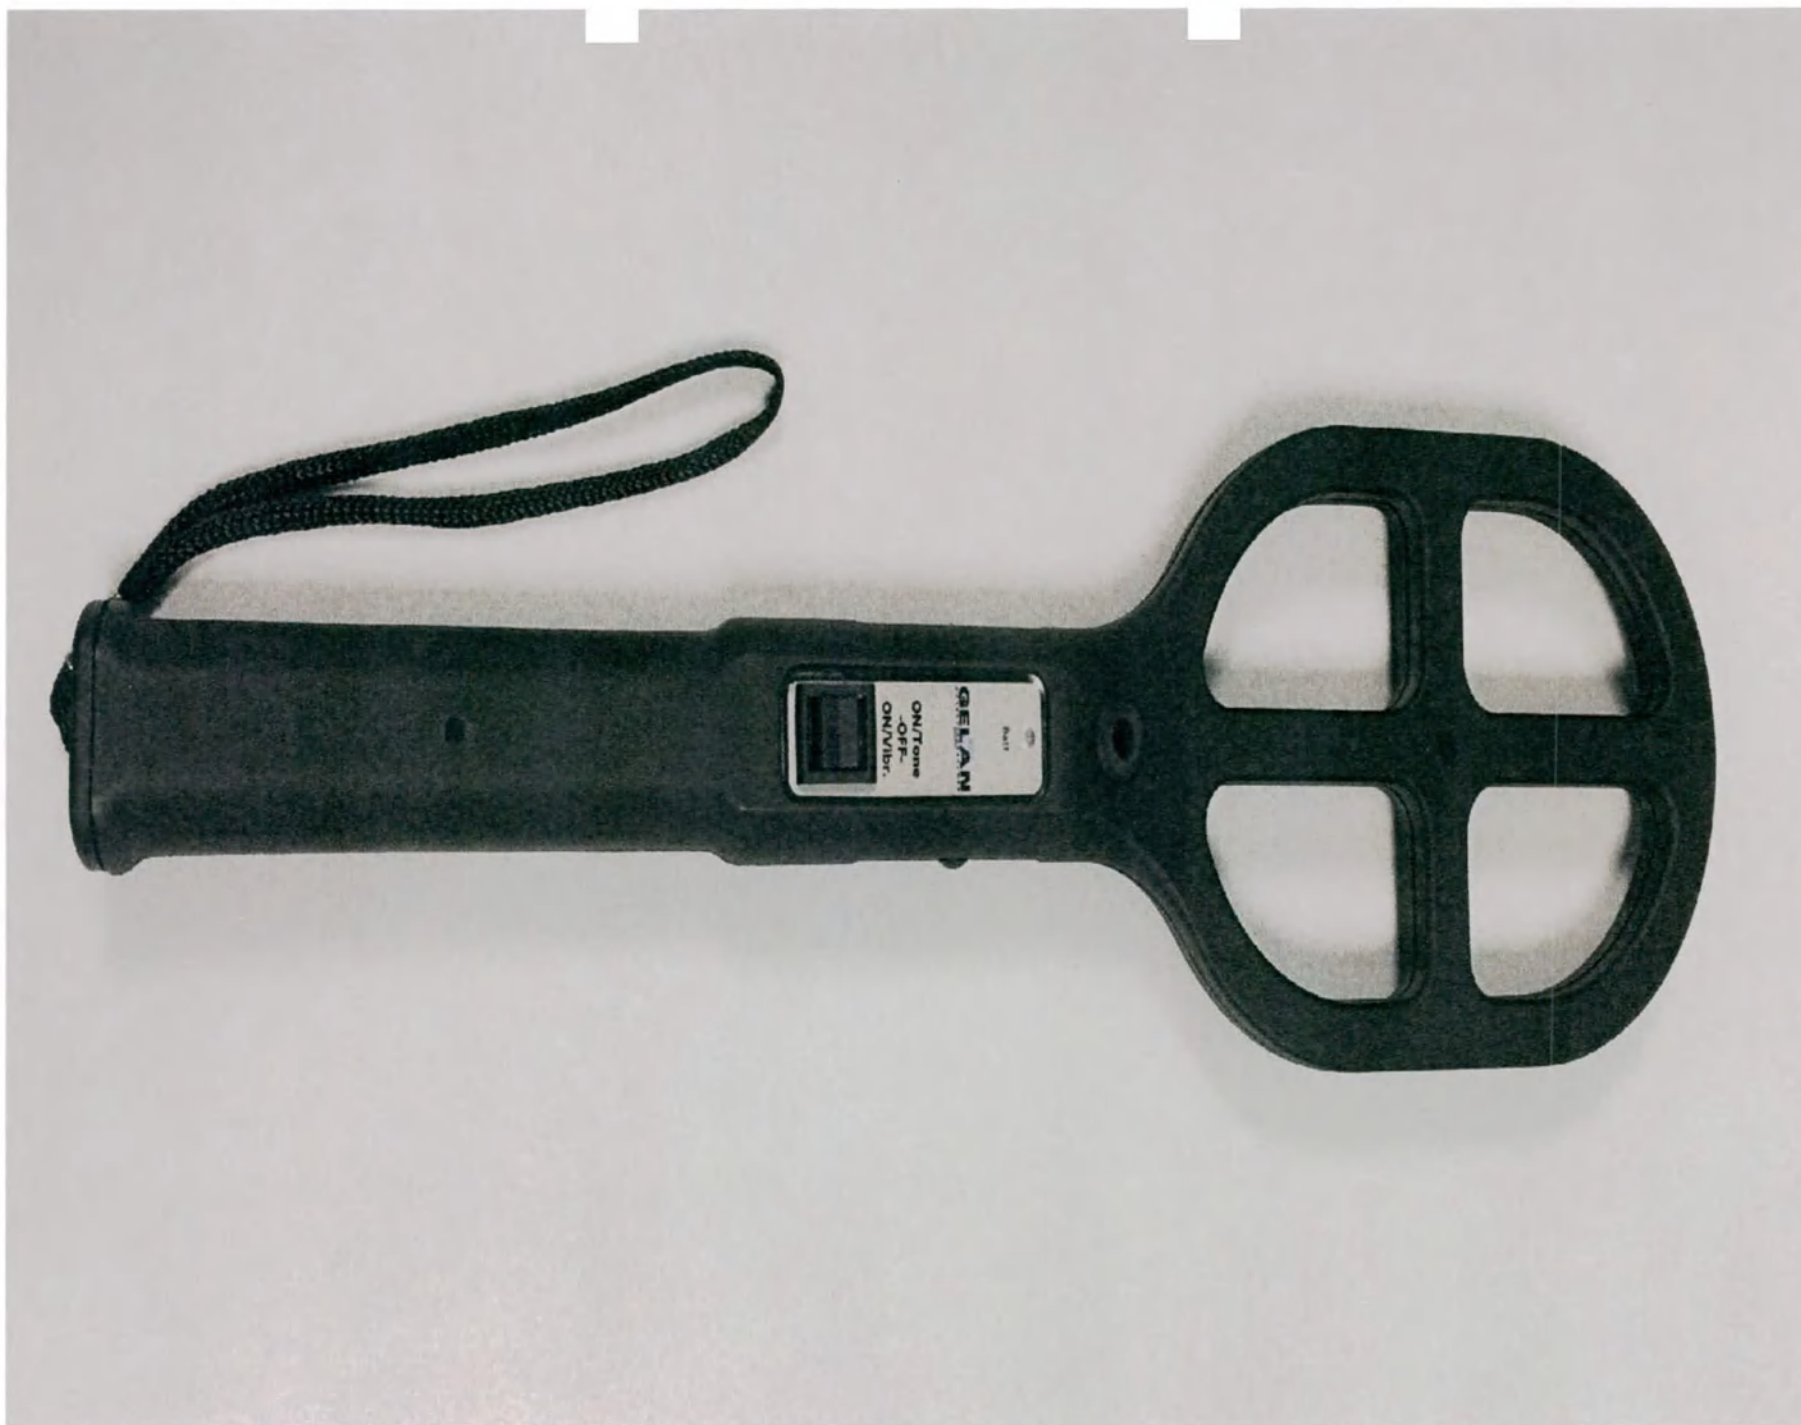

20. Портативный металлодетектор.



21. Кабина радиочастотная для защитного экранирования помещения.

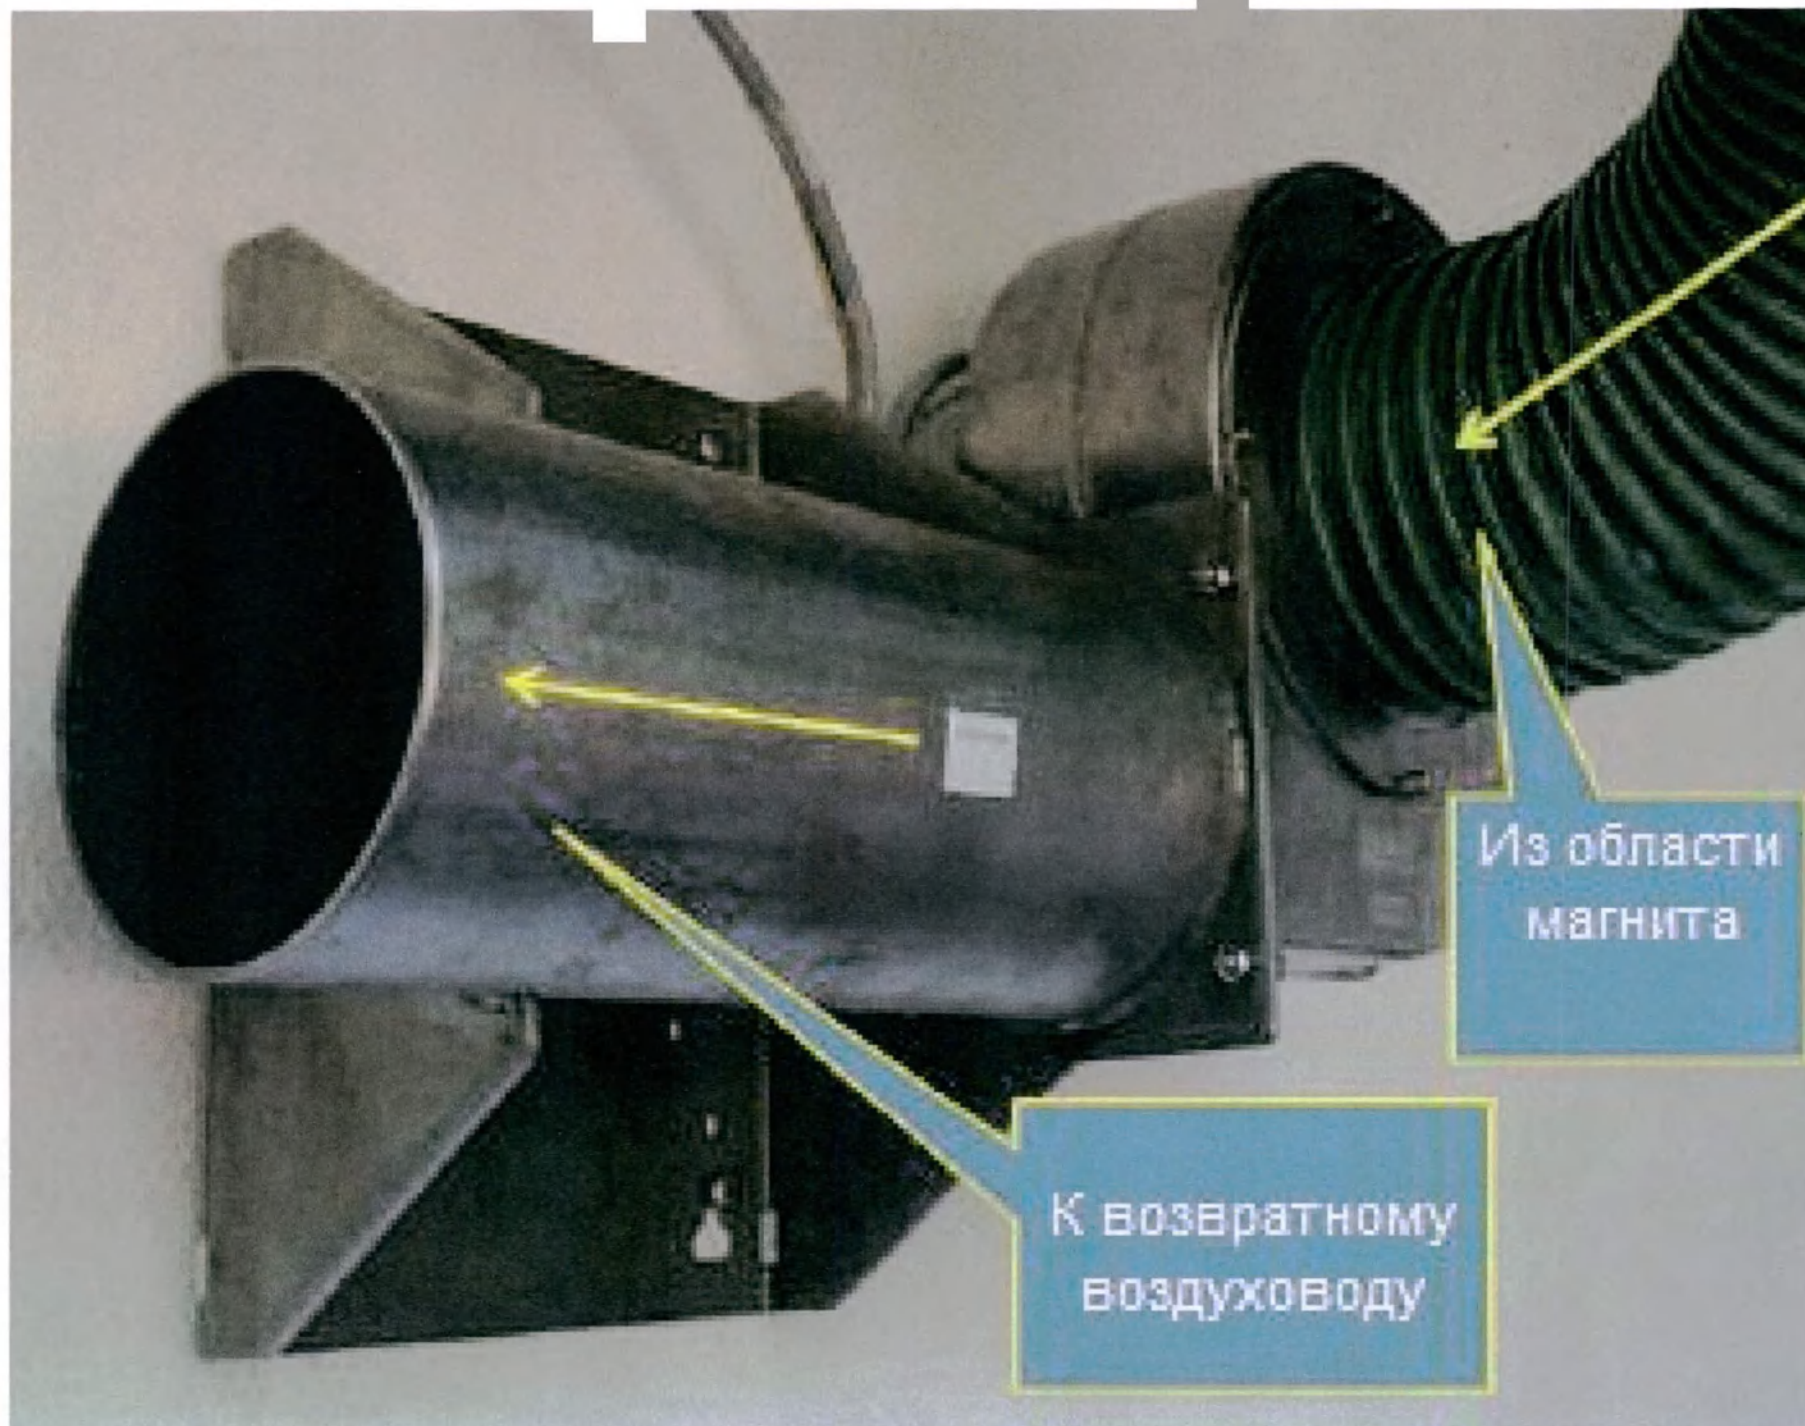


22. Система воздушного охлаждения.




22. Система воздушного охлаждения.




23. Блок охлаждения МР томографа.

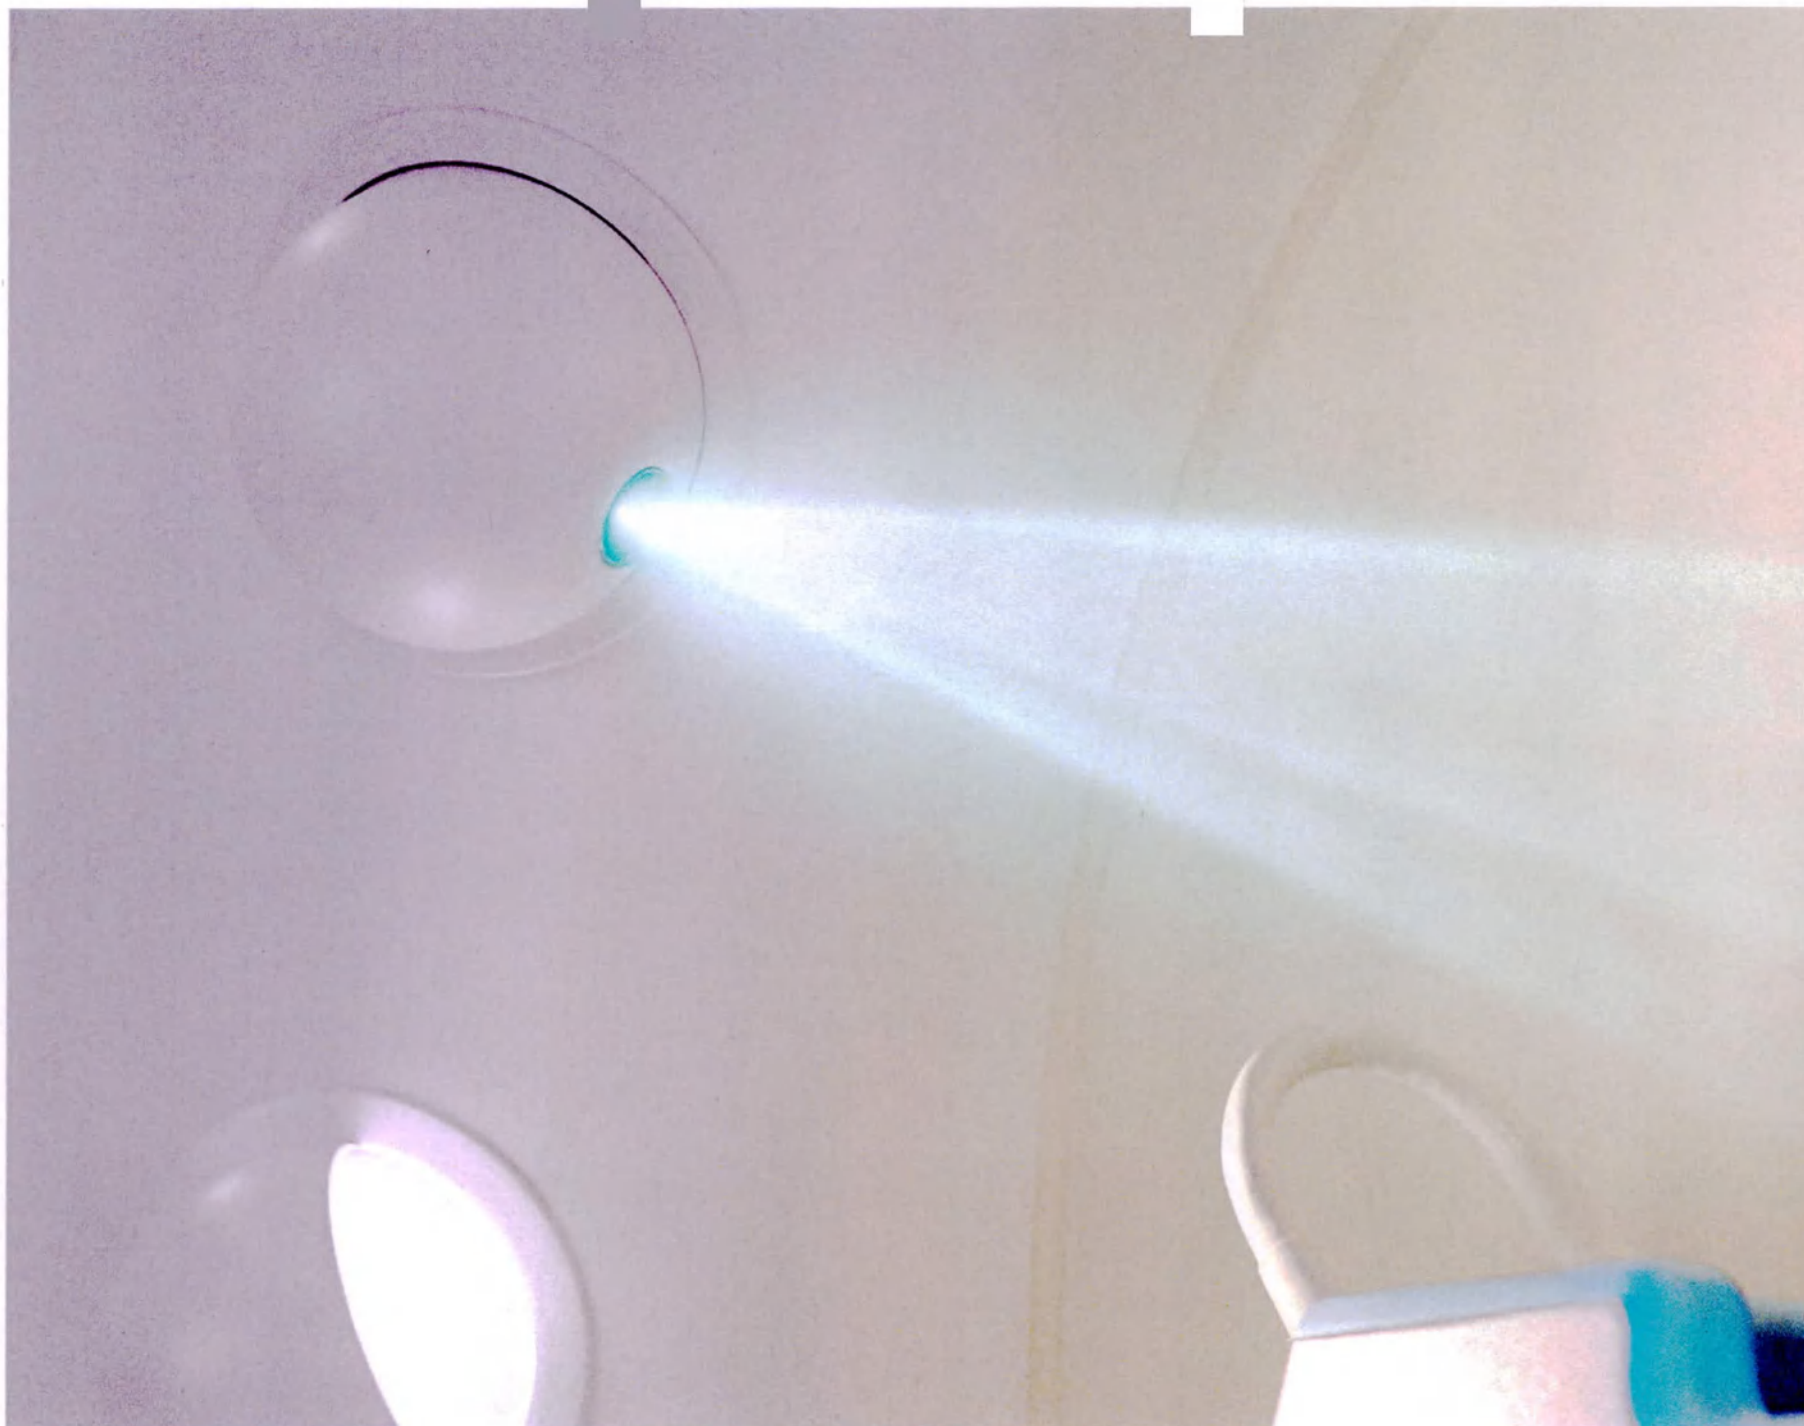

24. Система VitalEye.

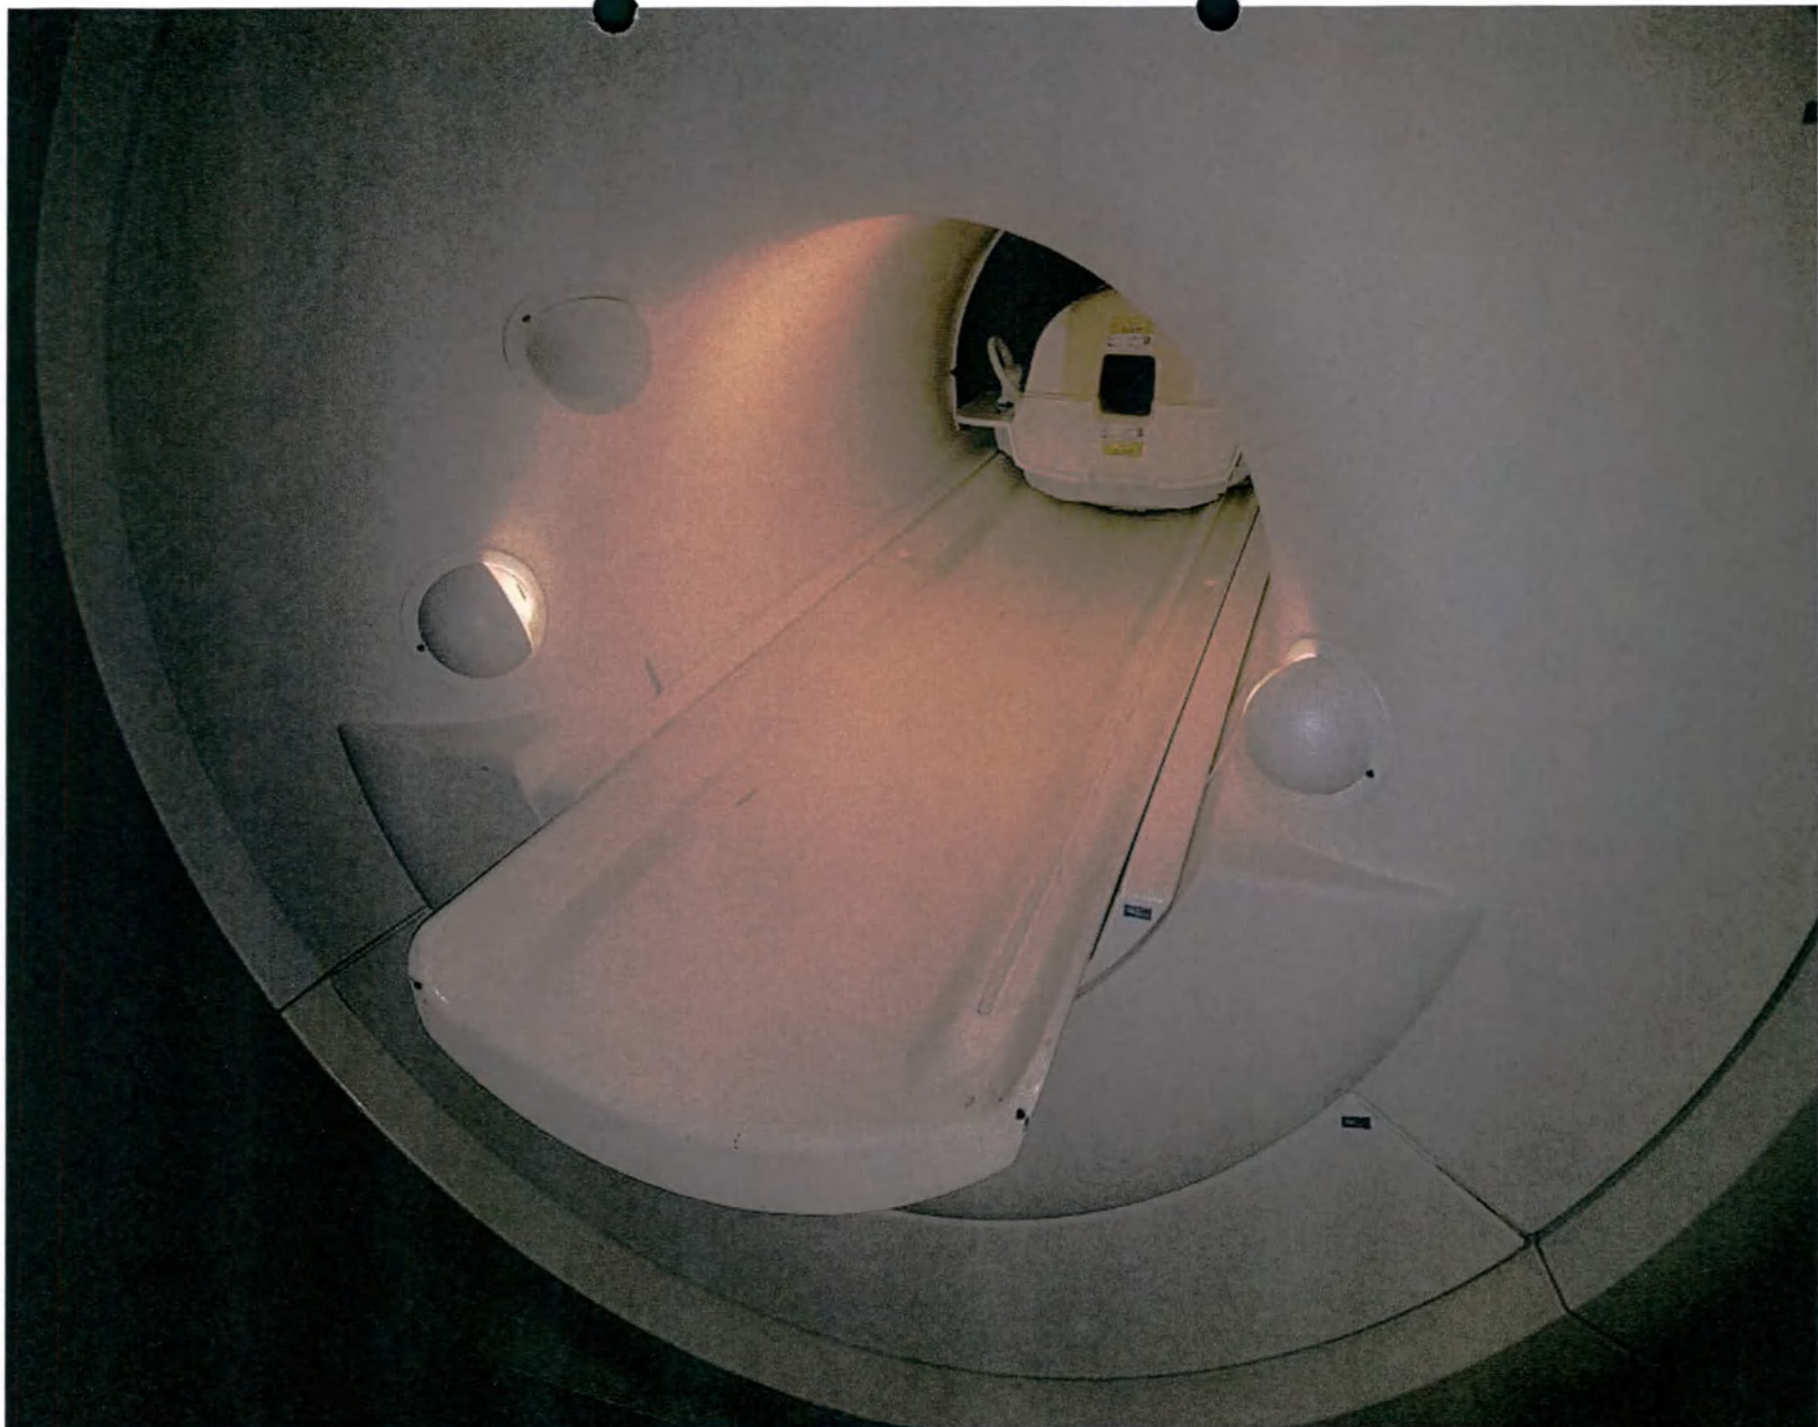


24. Система VitalEye.

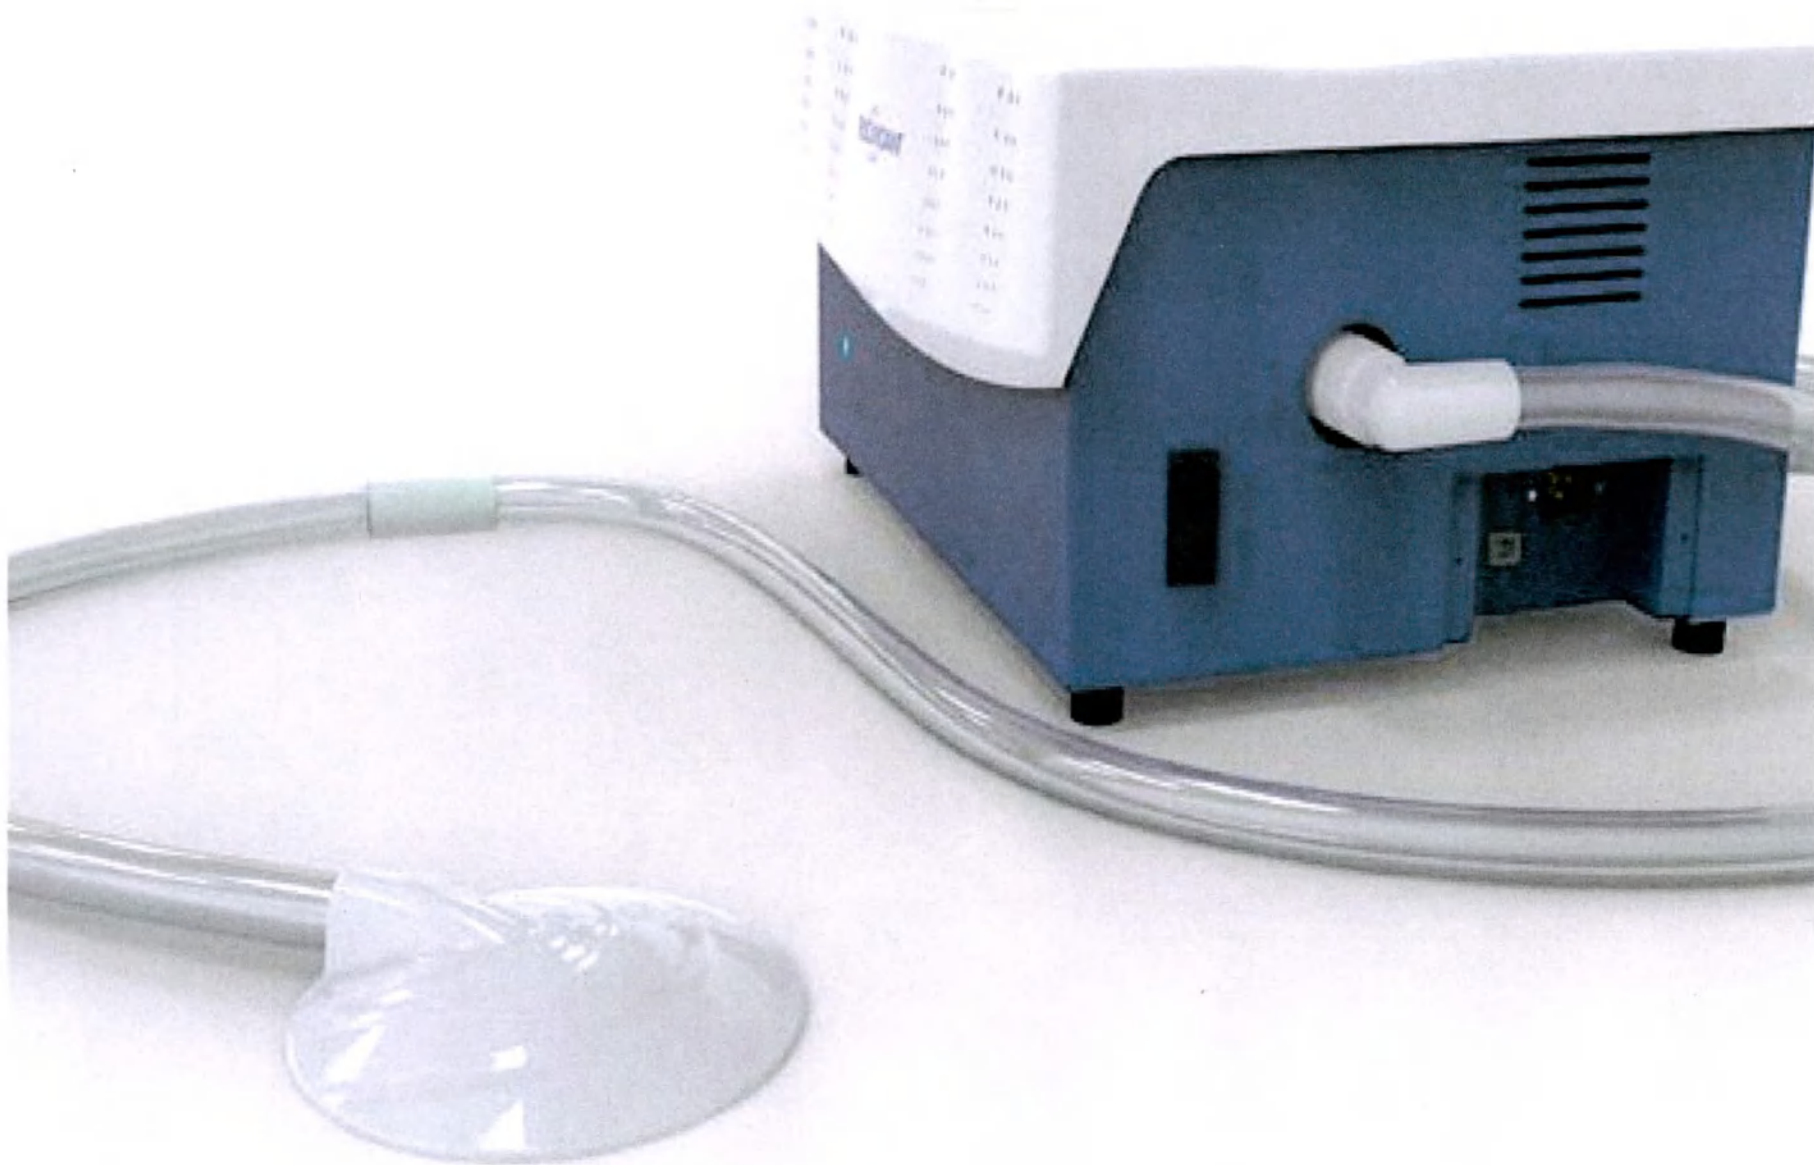


25. Система для эластографии.



26. Кабель питания.

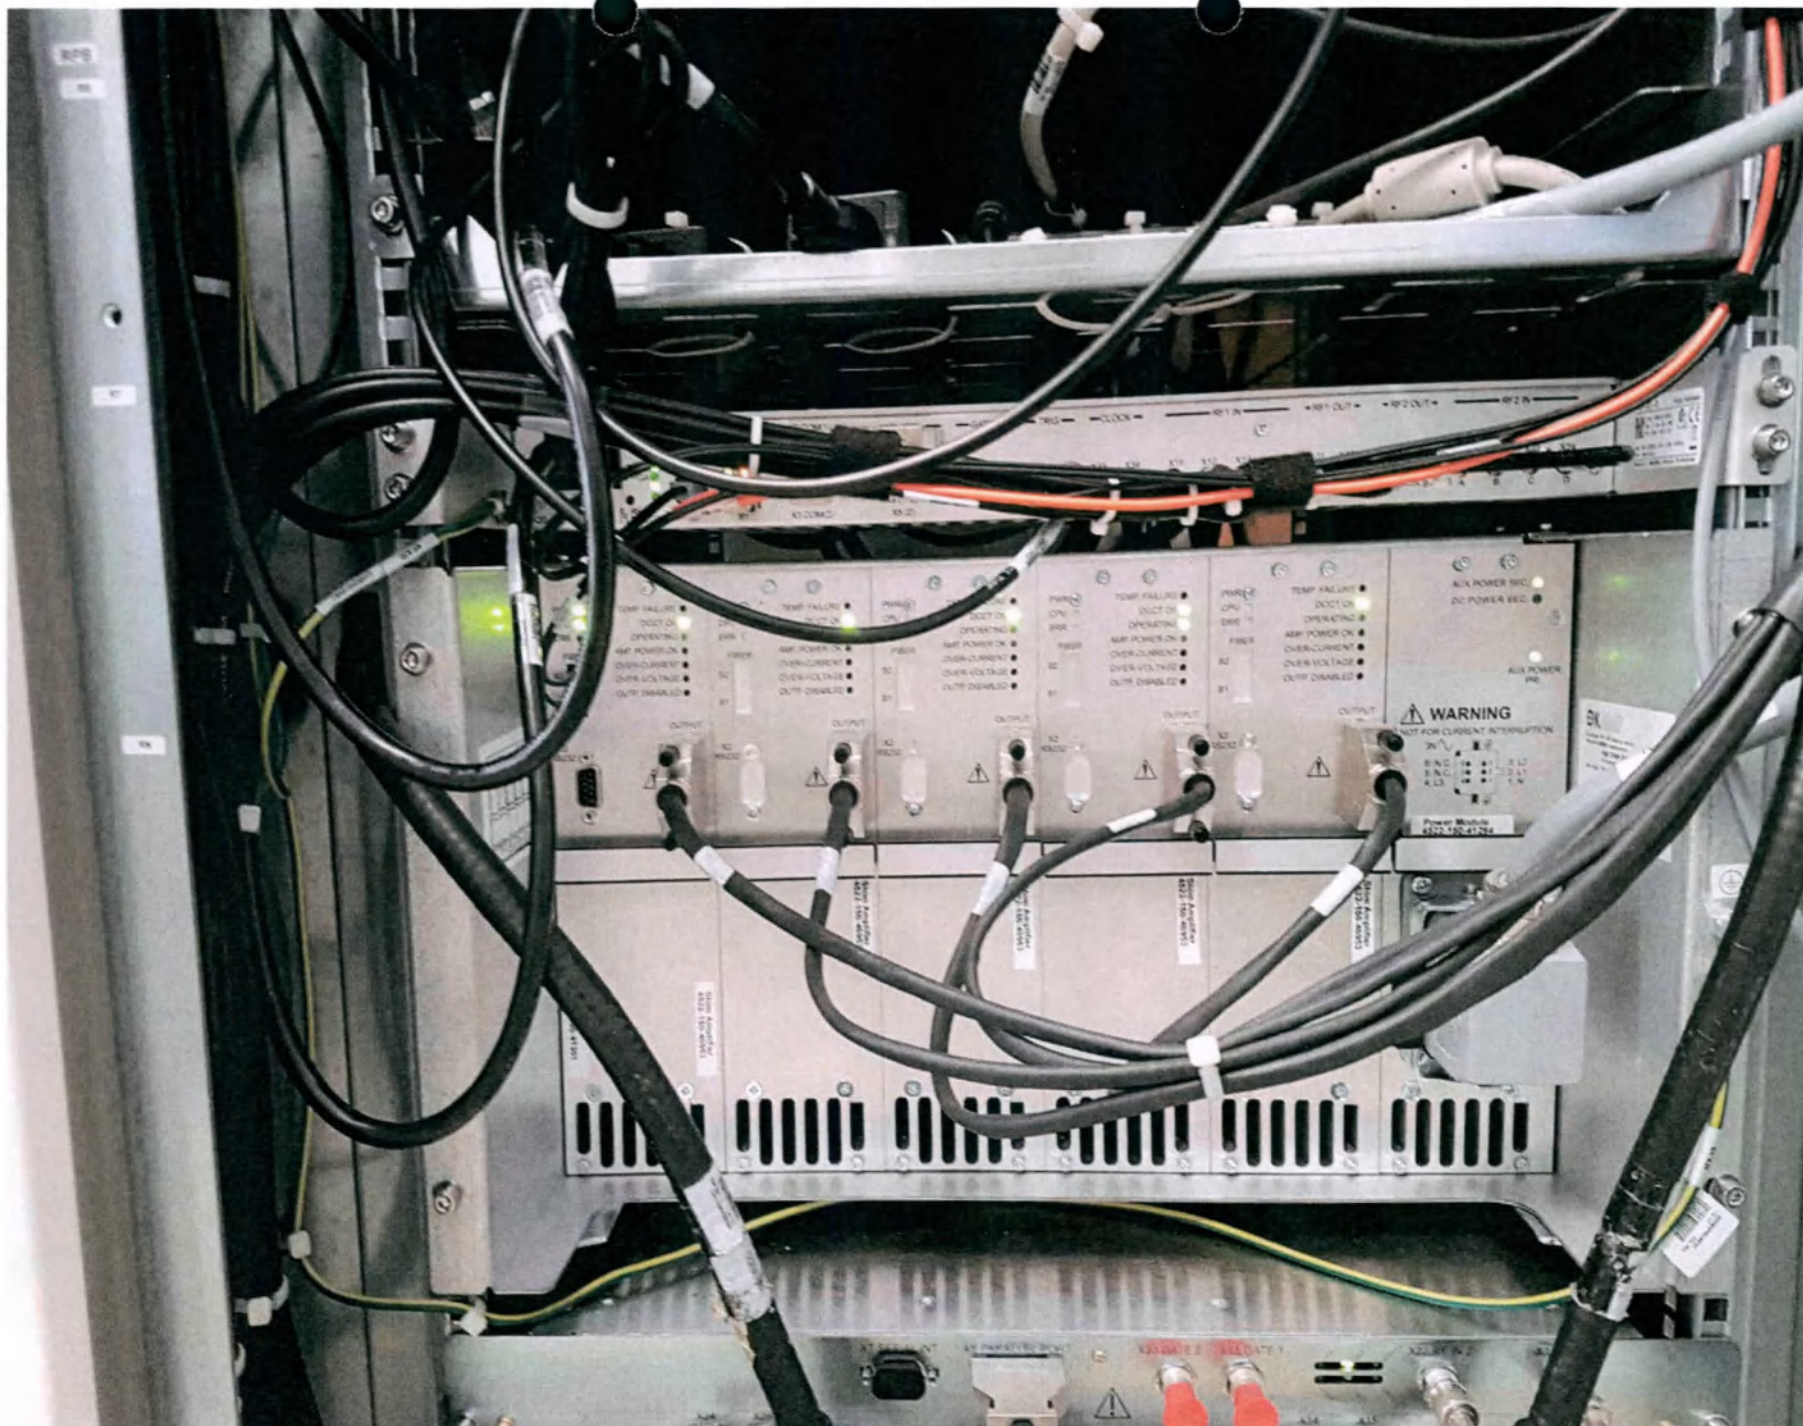

27. Кабель соединительный.

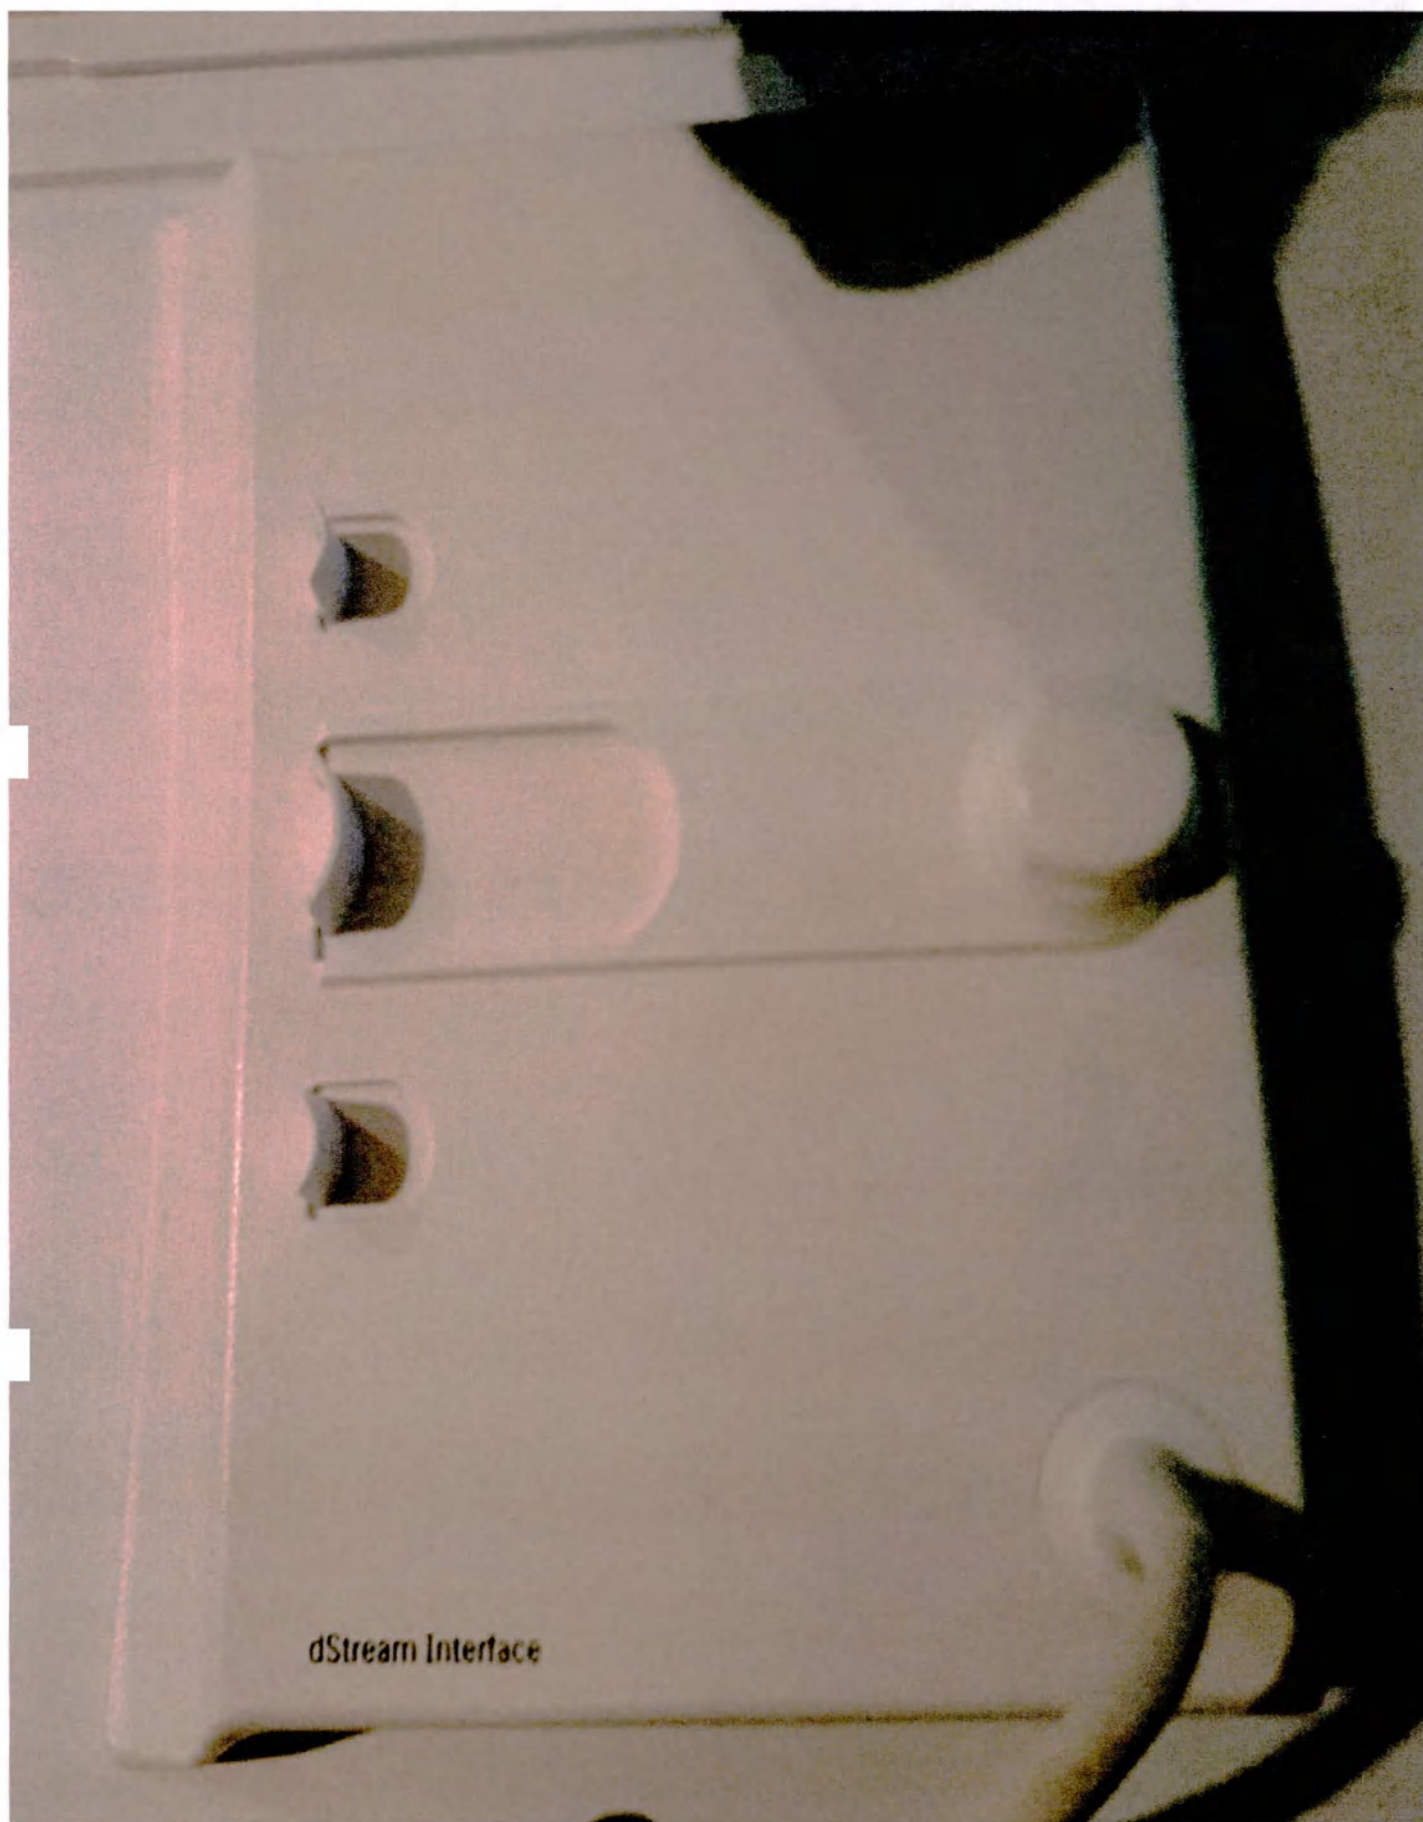

28. Интерфейс dStream Interface.

29. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных и/или виртуальных носителях, в составе:



Руководство по
эксплуатации

Русский

Release 11.1

Ingenia Ambition

3000 091 80991

PHILIPS

29.1. Руководство по эксплуатации.

**Дополнение к руководству по эксплуатации
медицинского изделия
«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia
Ambition с принадлежностями»**

29.2. Дополнение к руководству по эксплуатации



30. Камера мультиформатная термографическая Drystar 5302 с принадлежностями по РУ ФСЗ 2008/02792.



English (United States) ▼

IntelliSpace Portal

Image and Information Management Software
Version 12.1

LOT 12.1.2 REF 459801635933

Rx only Quantity 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request.

To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof.
Build: 12.1.2.11402

 Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



eIFU



2021-06-16




0197



(01)00884838093621
(11)210616 (10)12.1.2

31. Обеспечение программное медицинское для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных и виртуальных носителях с принадлежностями, производства «Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.», Нидерланды, РУ № РЗН 2018/6795


7. Тележка пациента:

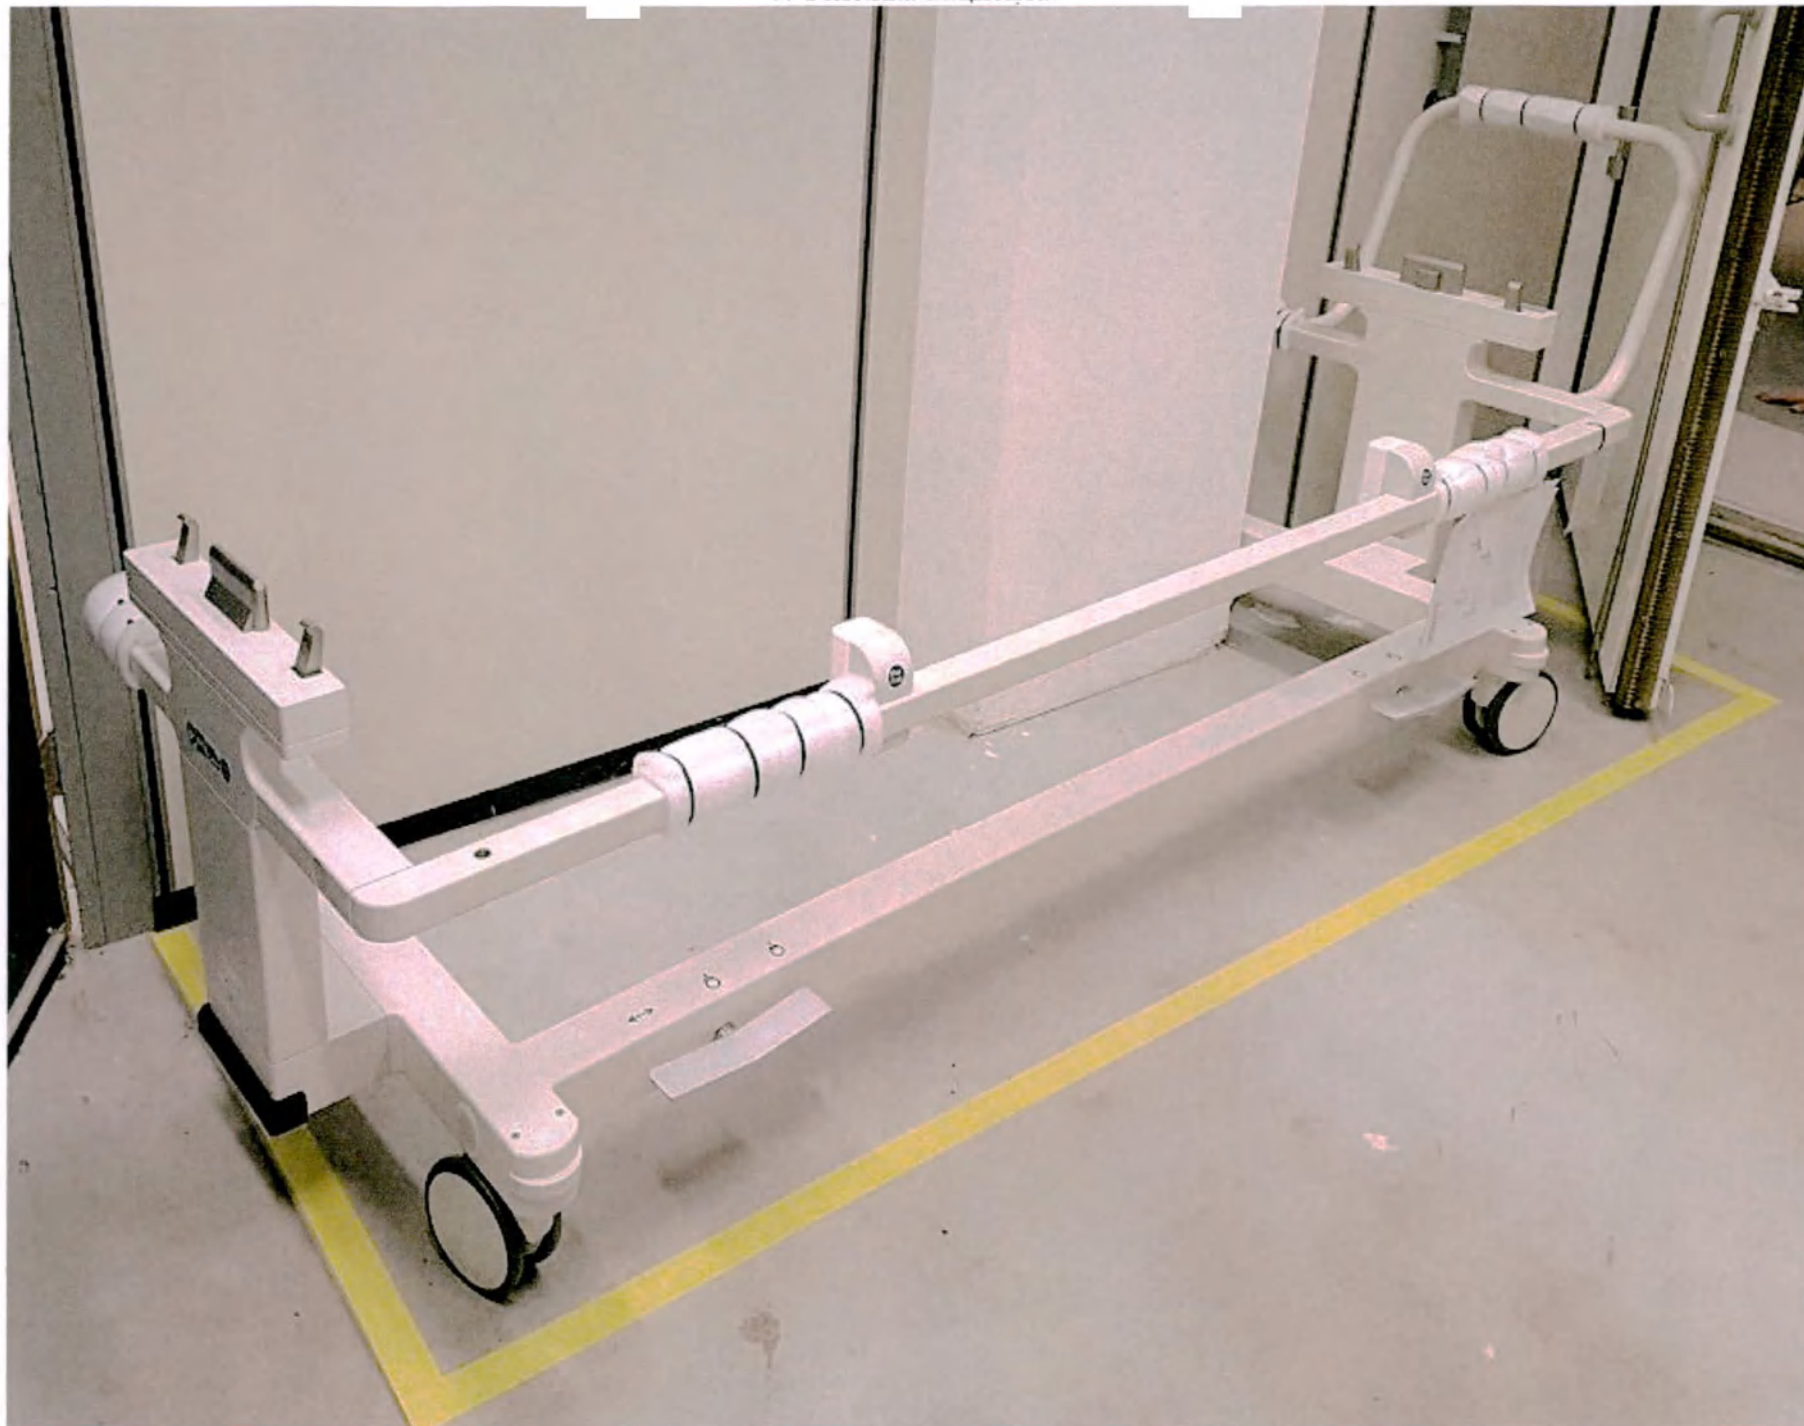

7.1. FlexTrak FH.




7.2. FlexTrak HA.

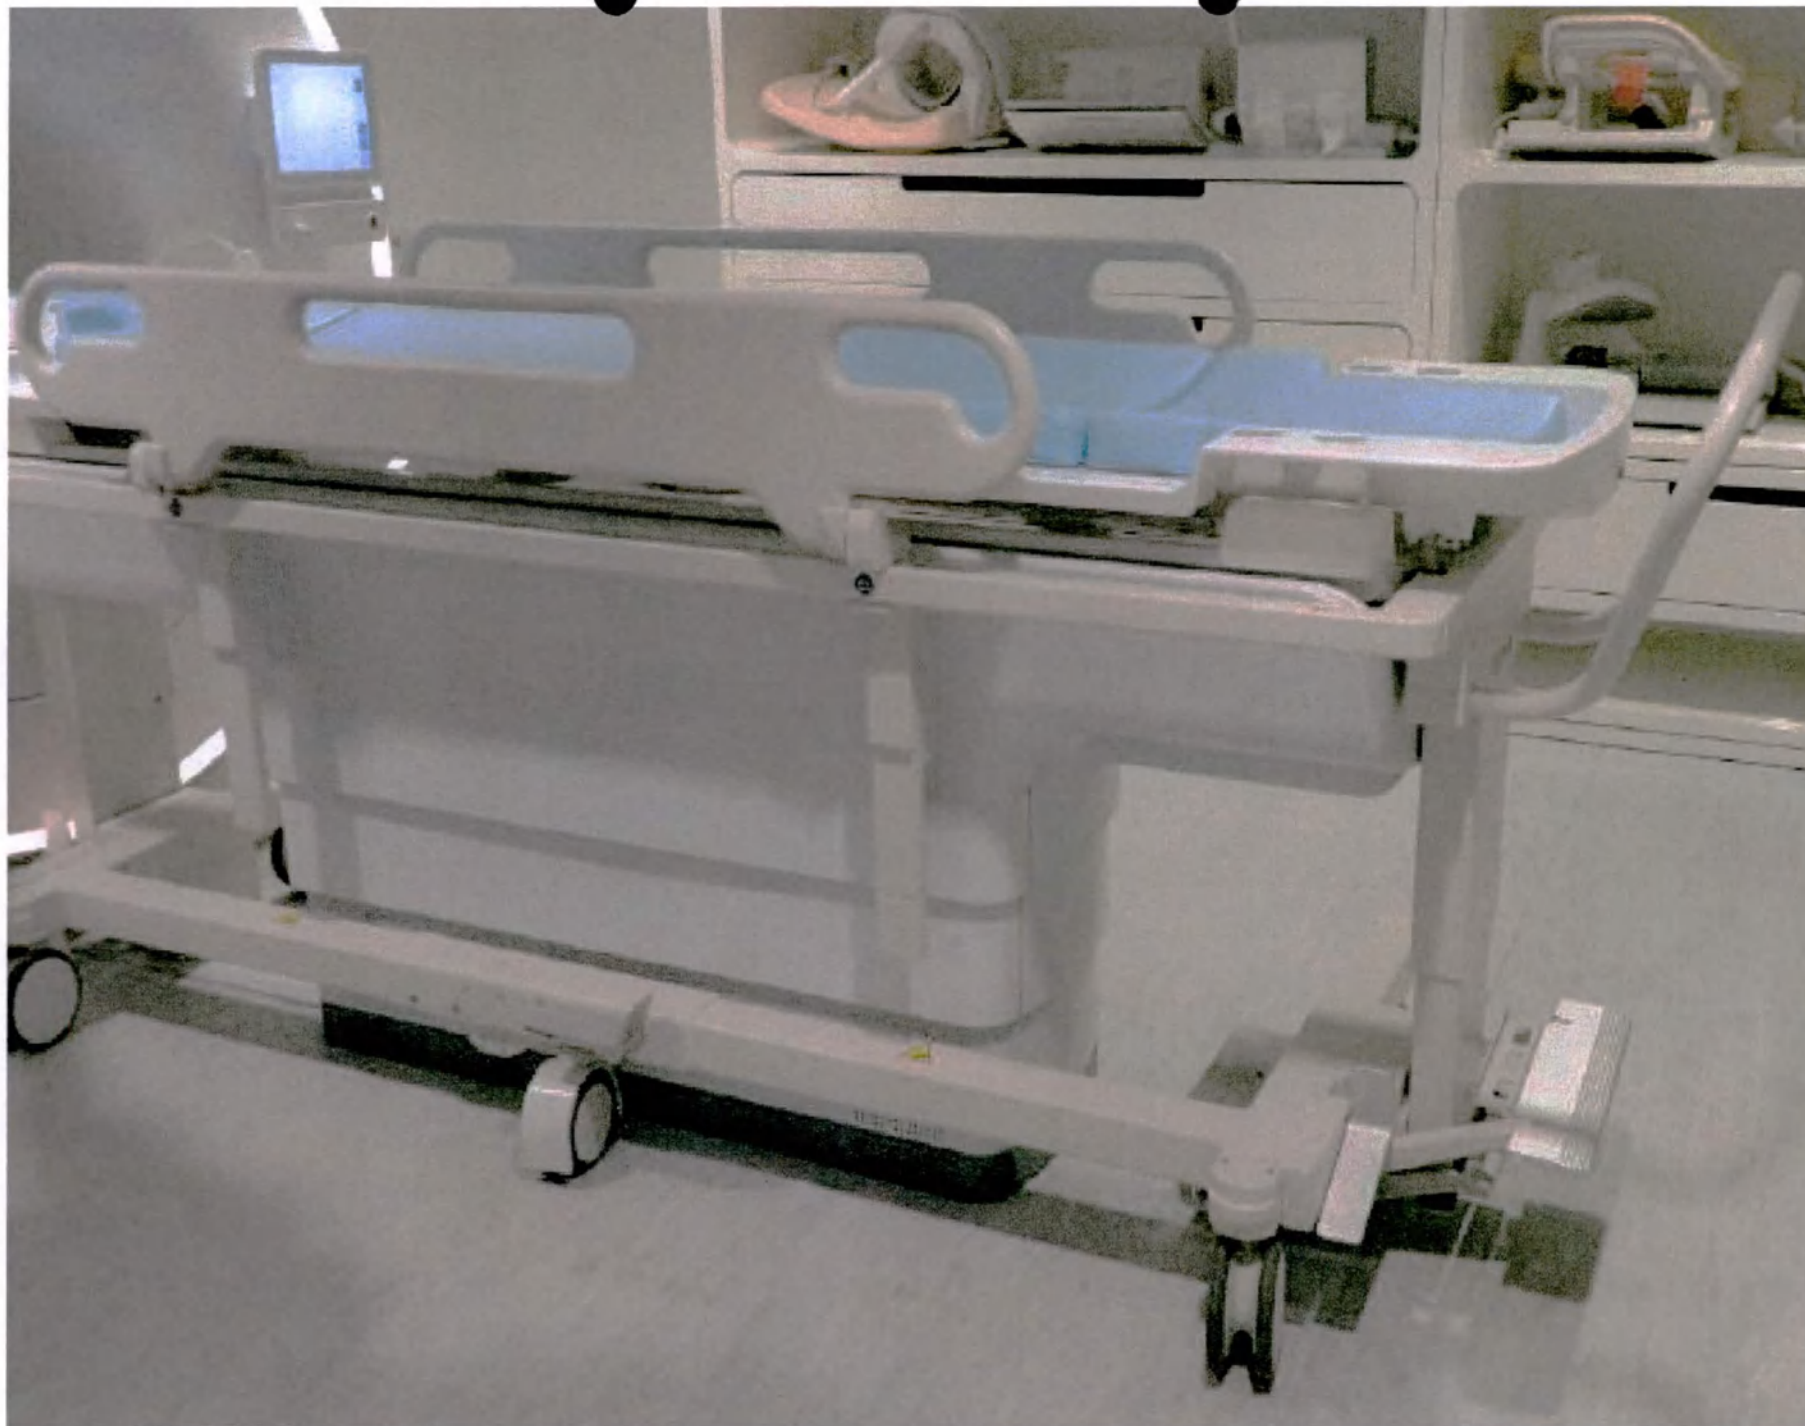

7.3. FlexTrak HA-II.

Принадлежности:

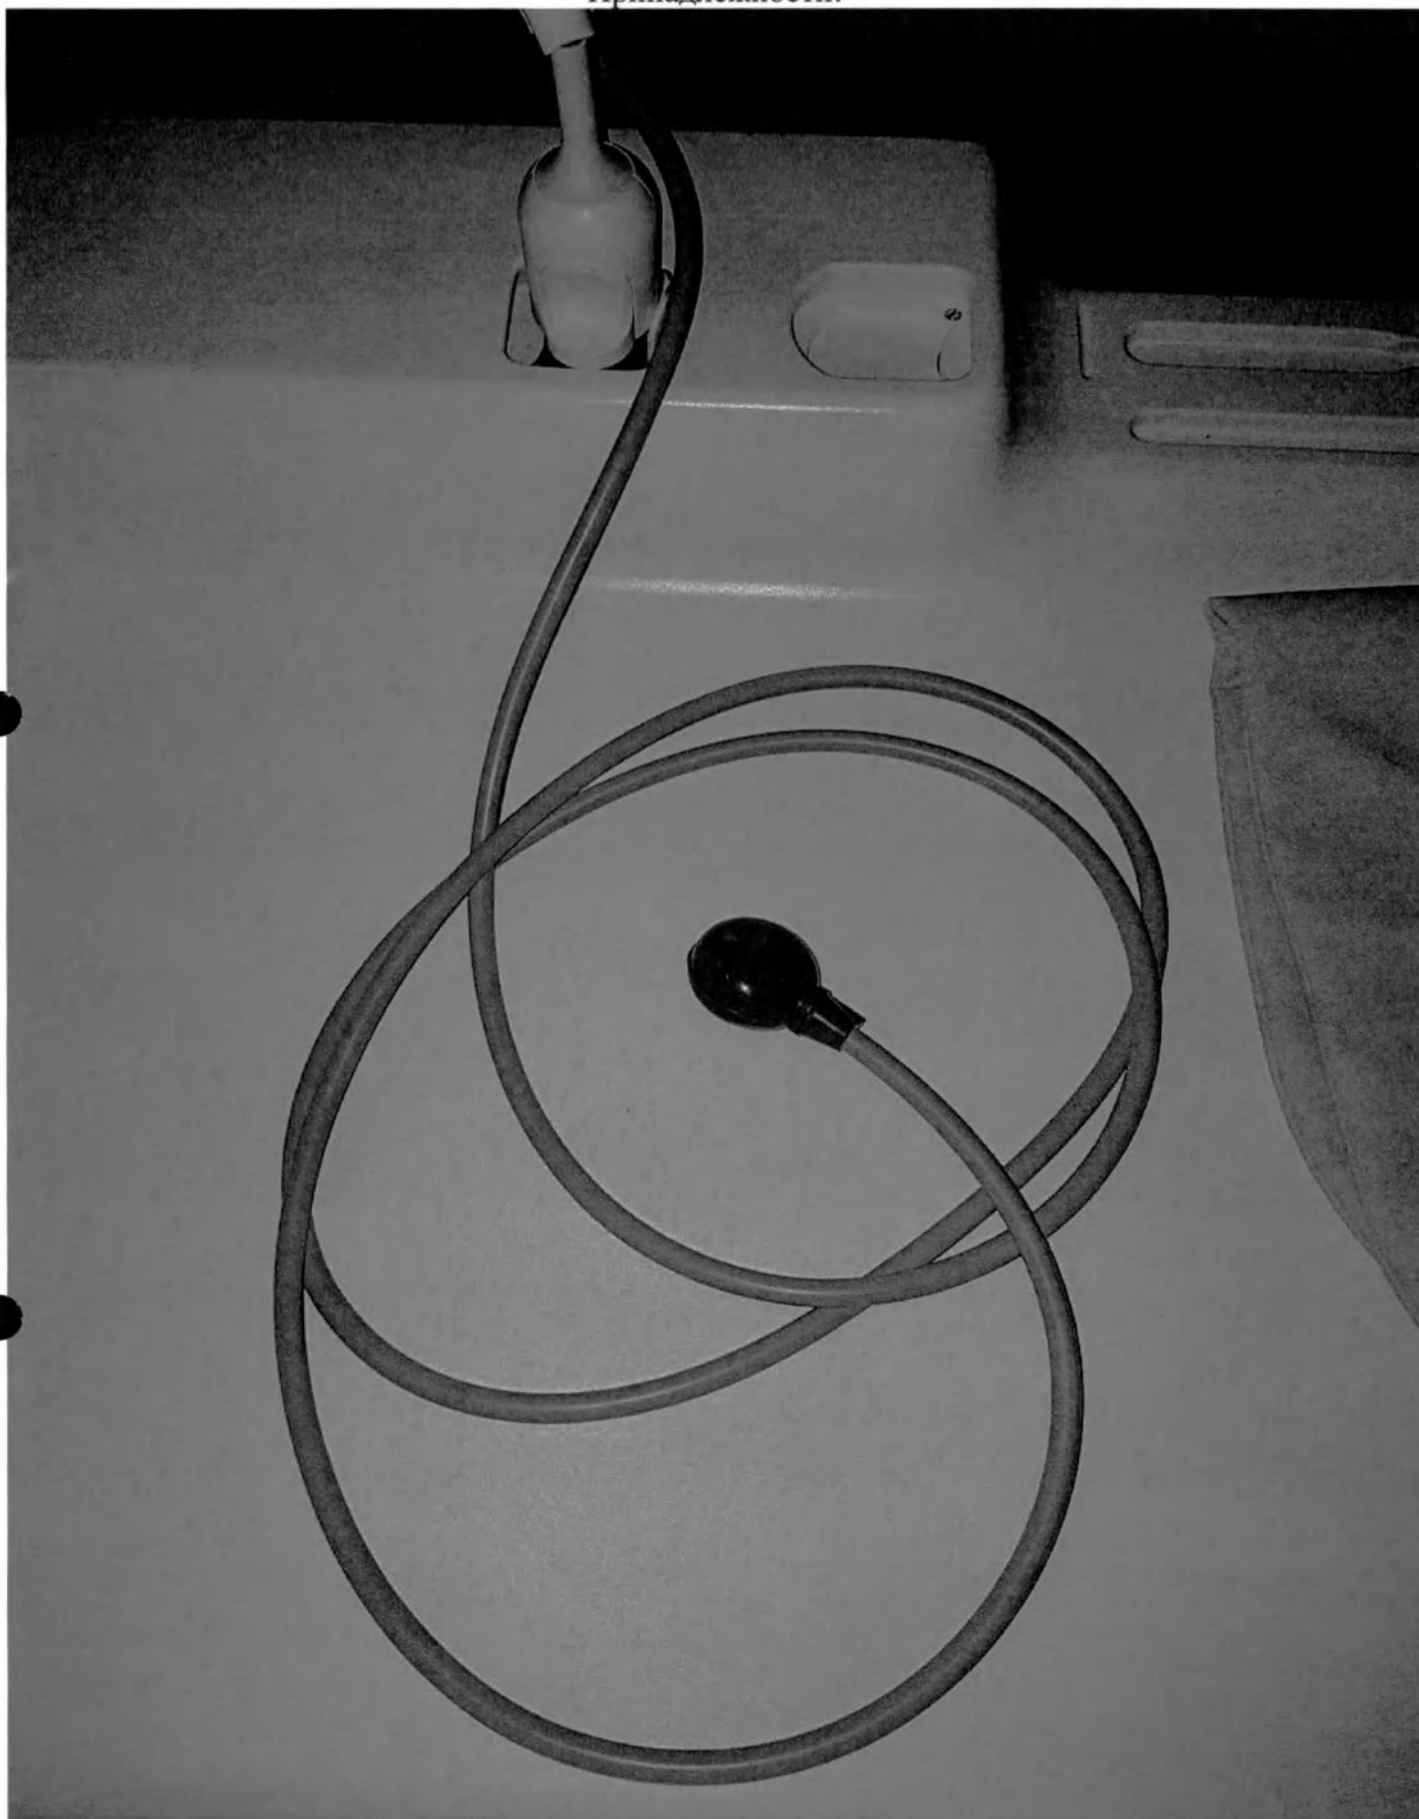

1. Кнопка вызова медсестры.



2. Наушники.



2. Наушники.



3. Устройство Caddy для катушек.



3. Устройство Caddy для катушек.




4. Шкаф для катушек.




5. Ящик для фантомов.

6. Фантомы:

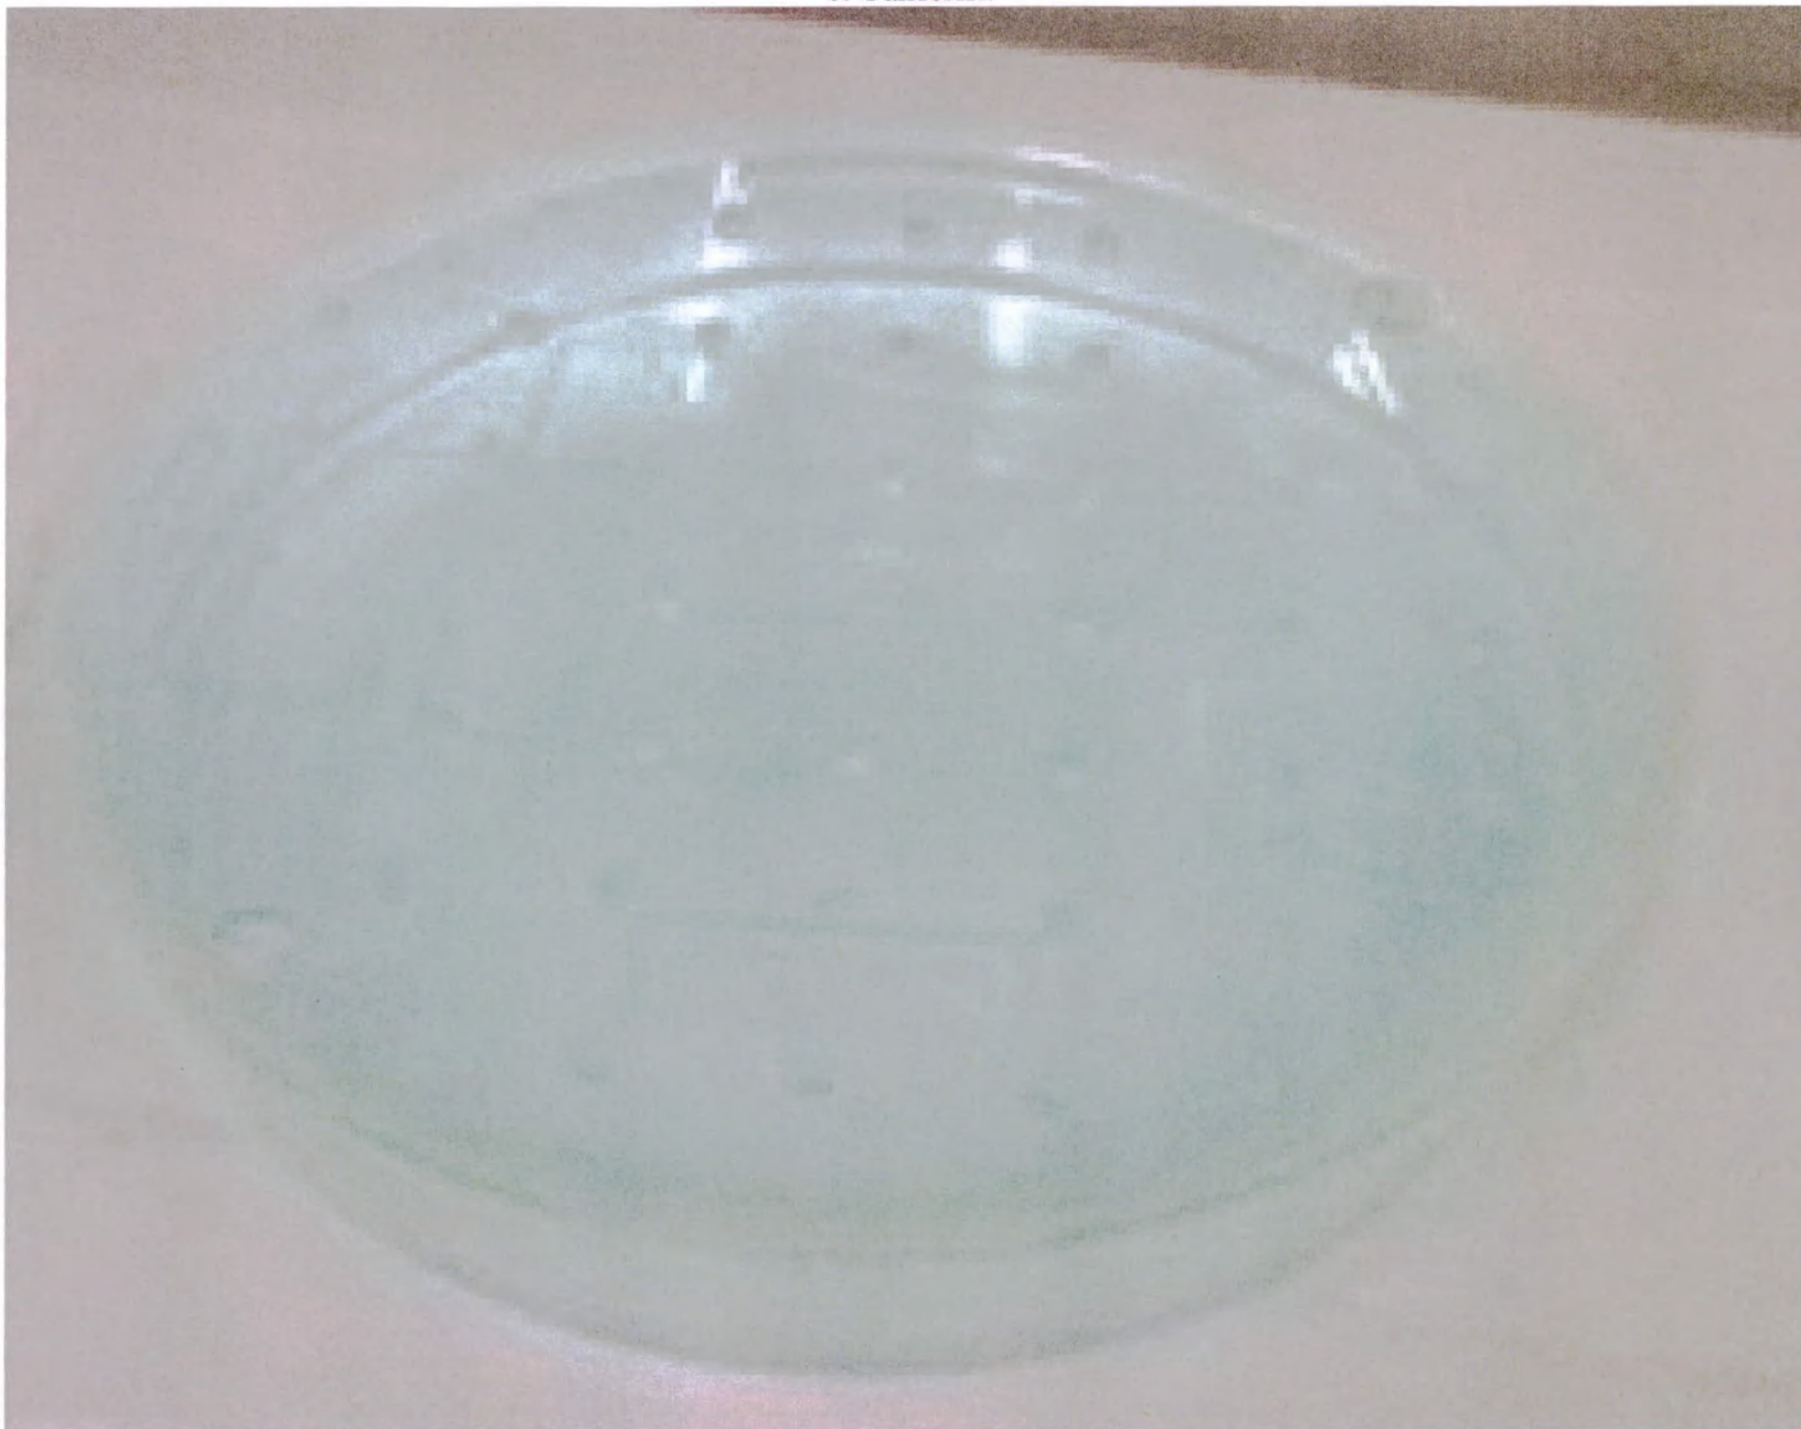

6.1. Фантом тела (400 мм).

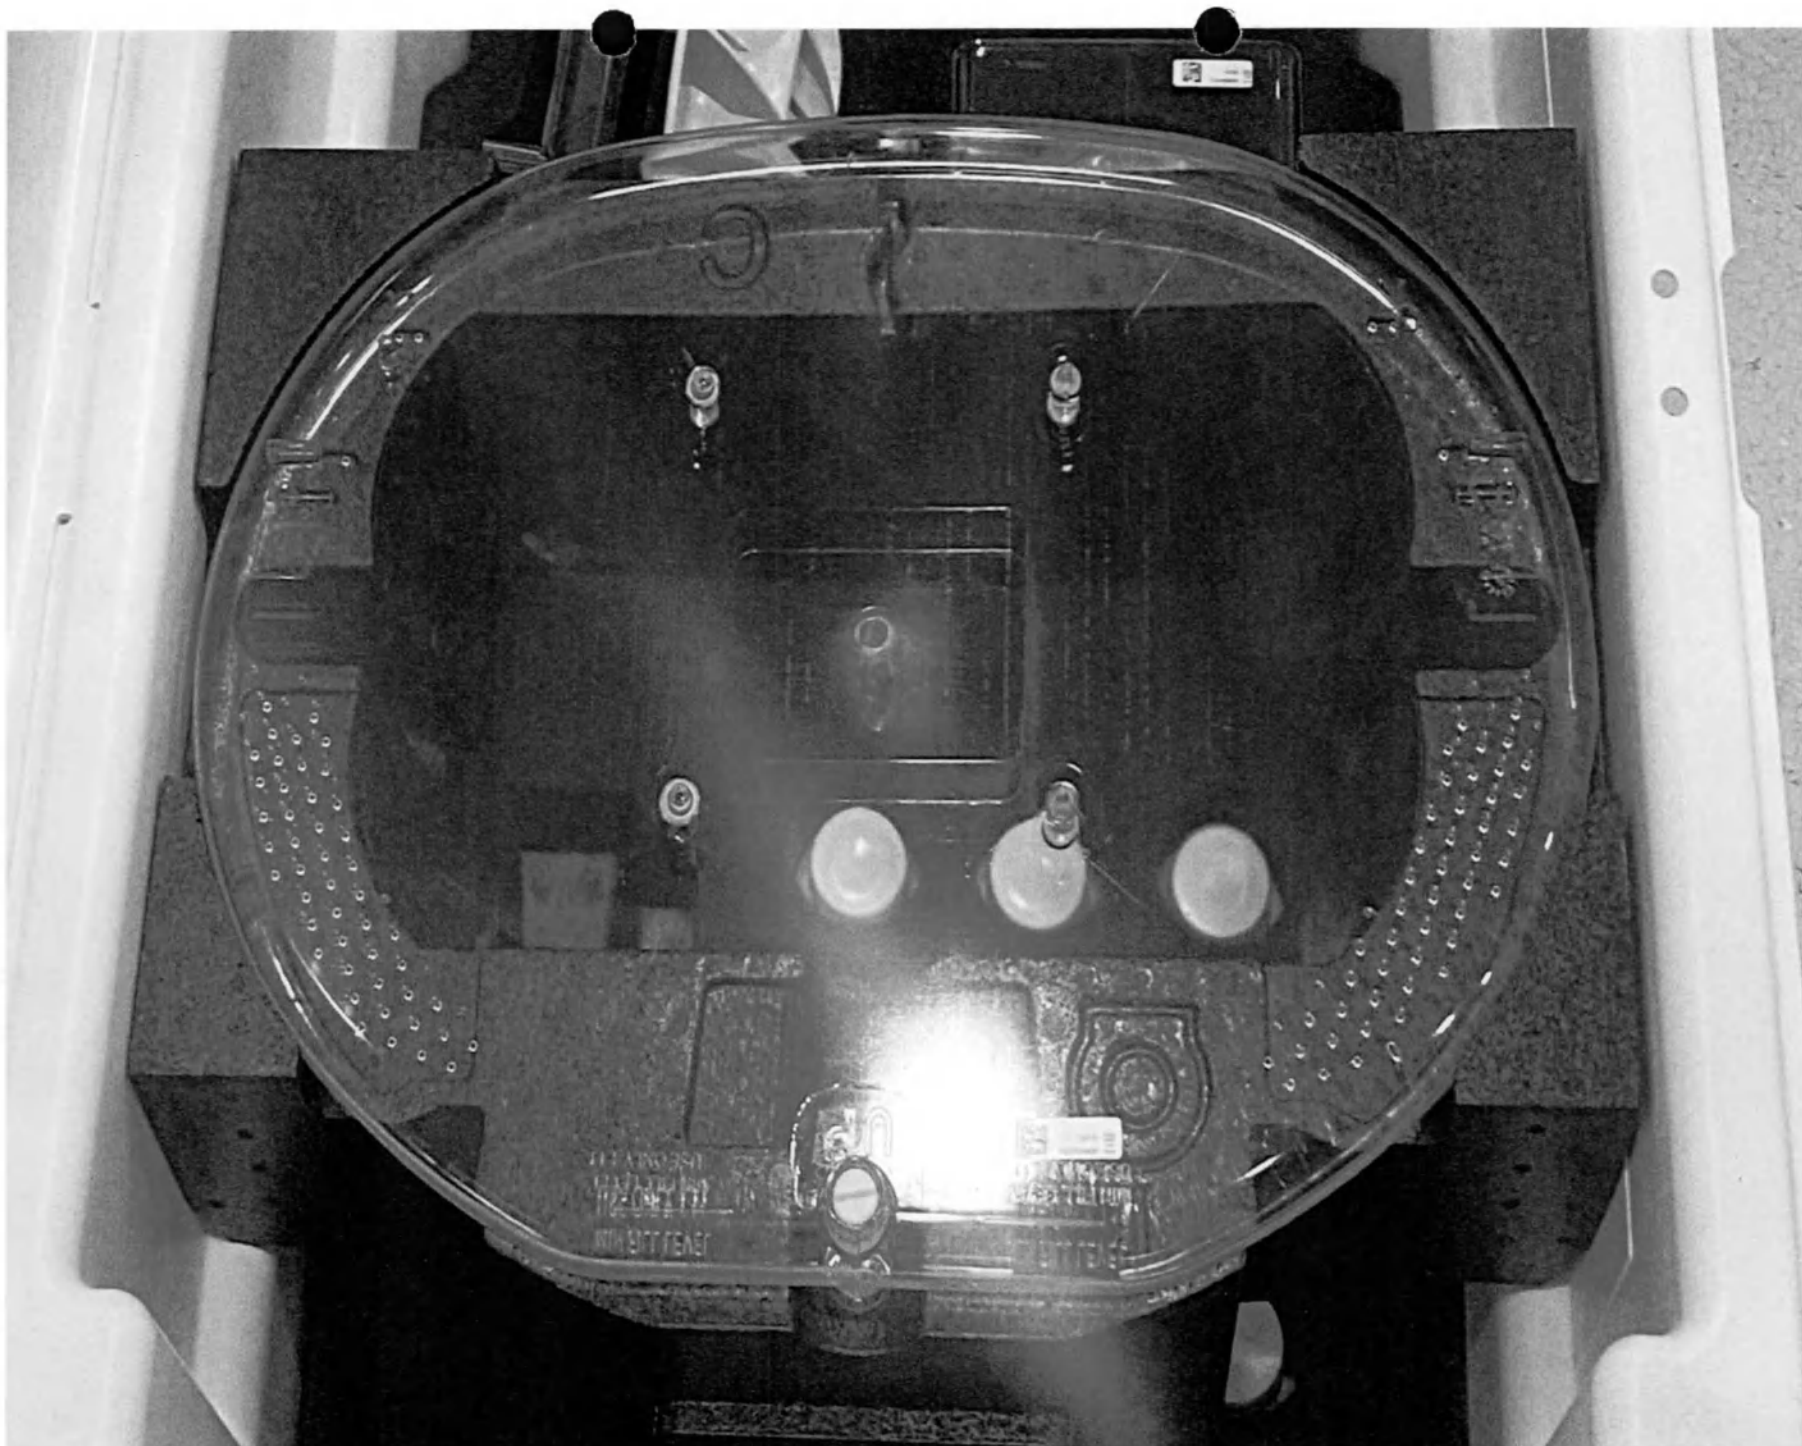

6.2. Фантом тела (530 мм).




6.3. Фантом головы (200 мм).




6.4. Бутылочный фантом в вариантах исполнения: 2000сс и/или 3000сс и/или 5000сс.



6.5. Бутылочный фантом (АЦПК).

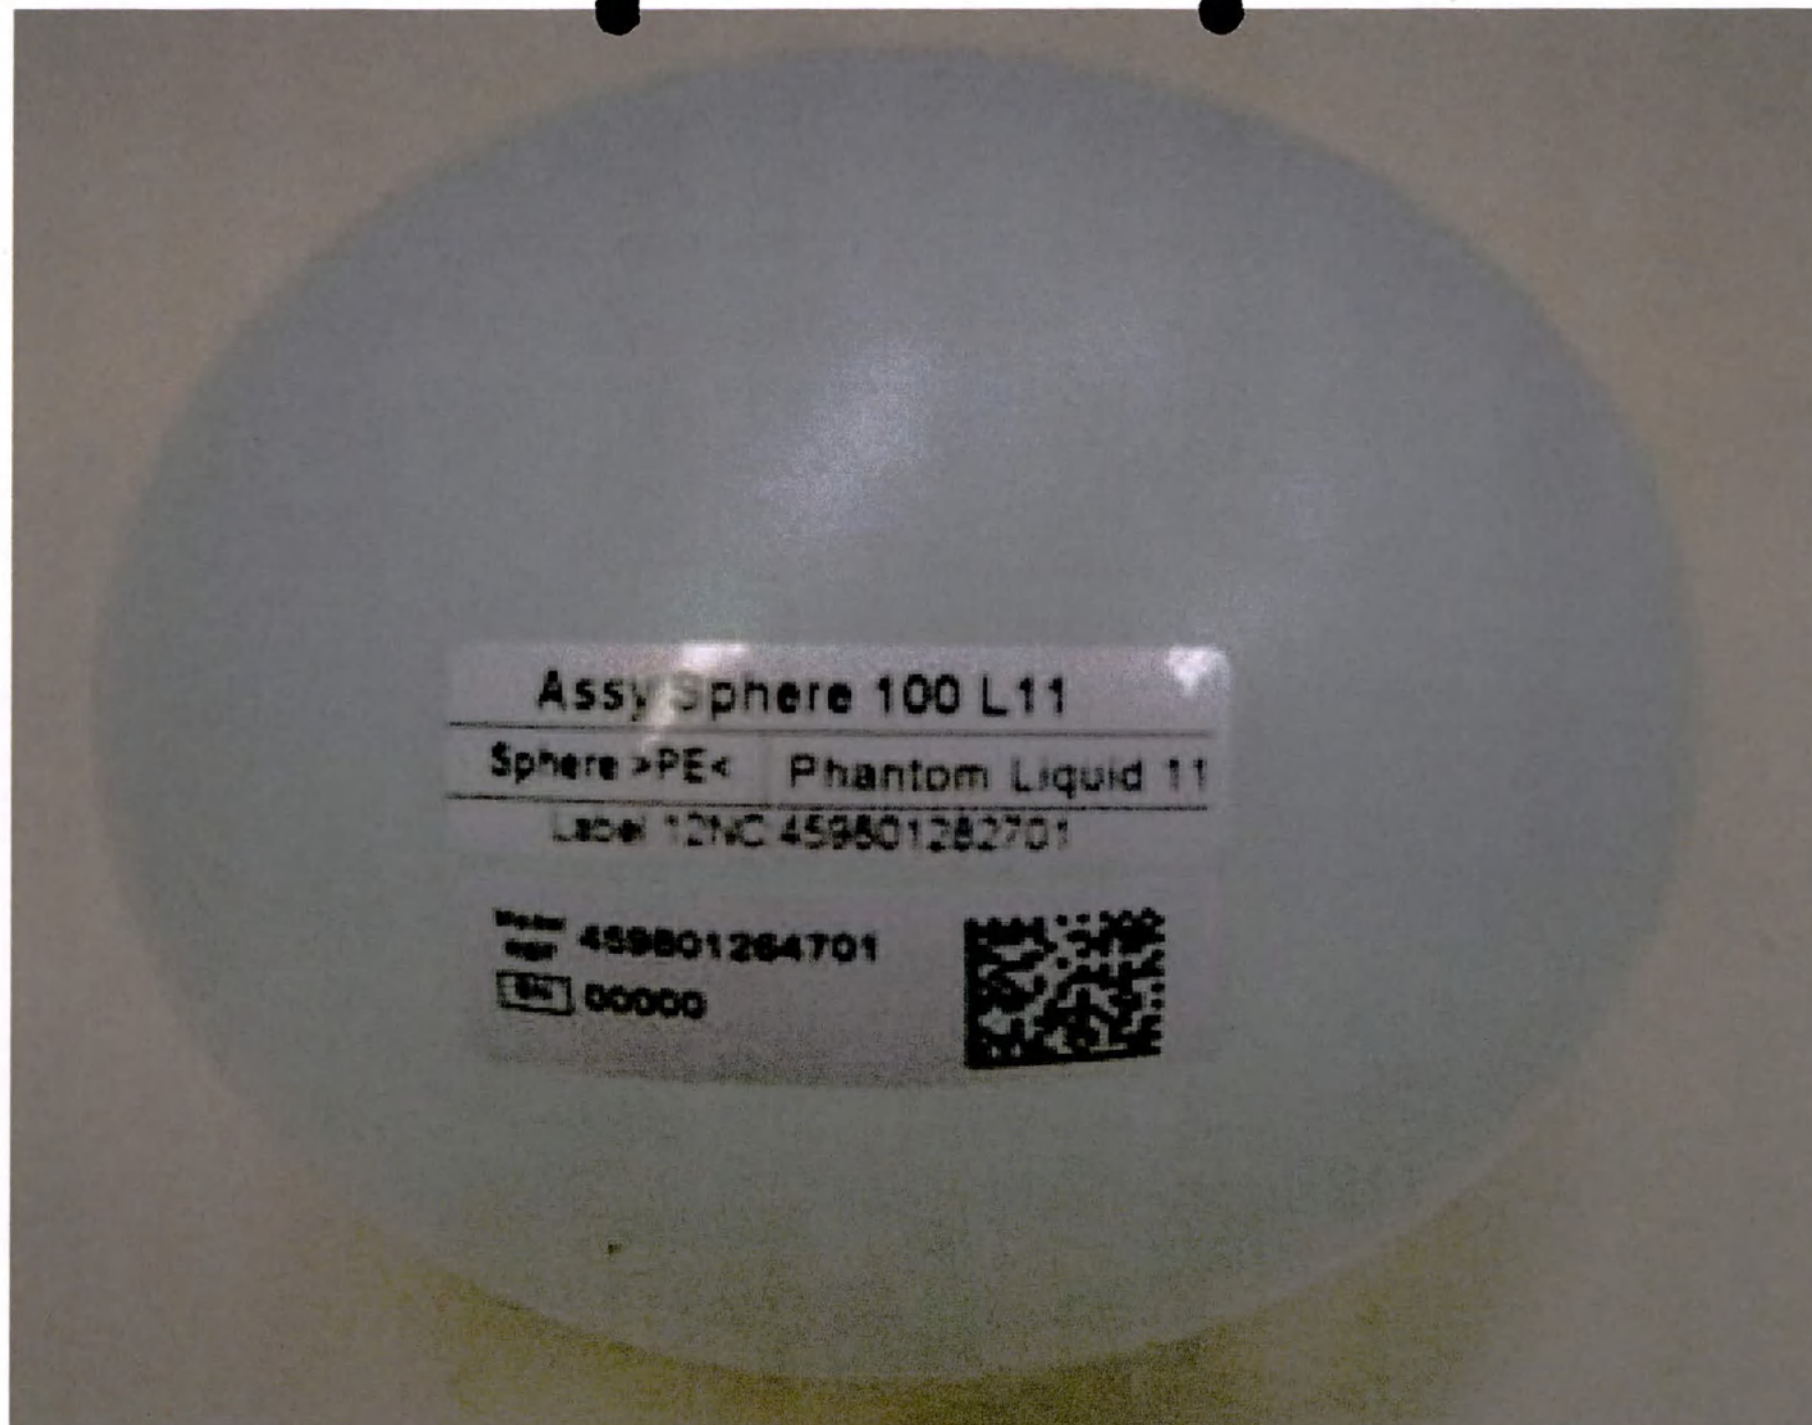

6.6. Сферический фантом.

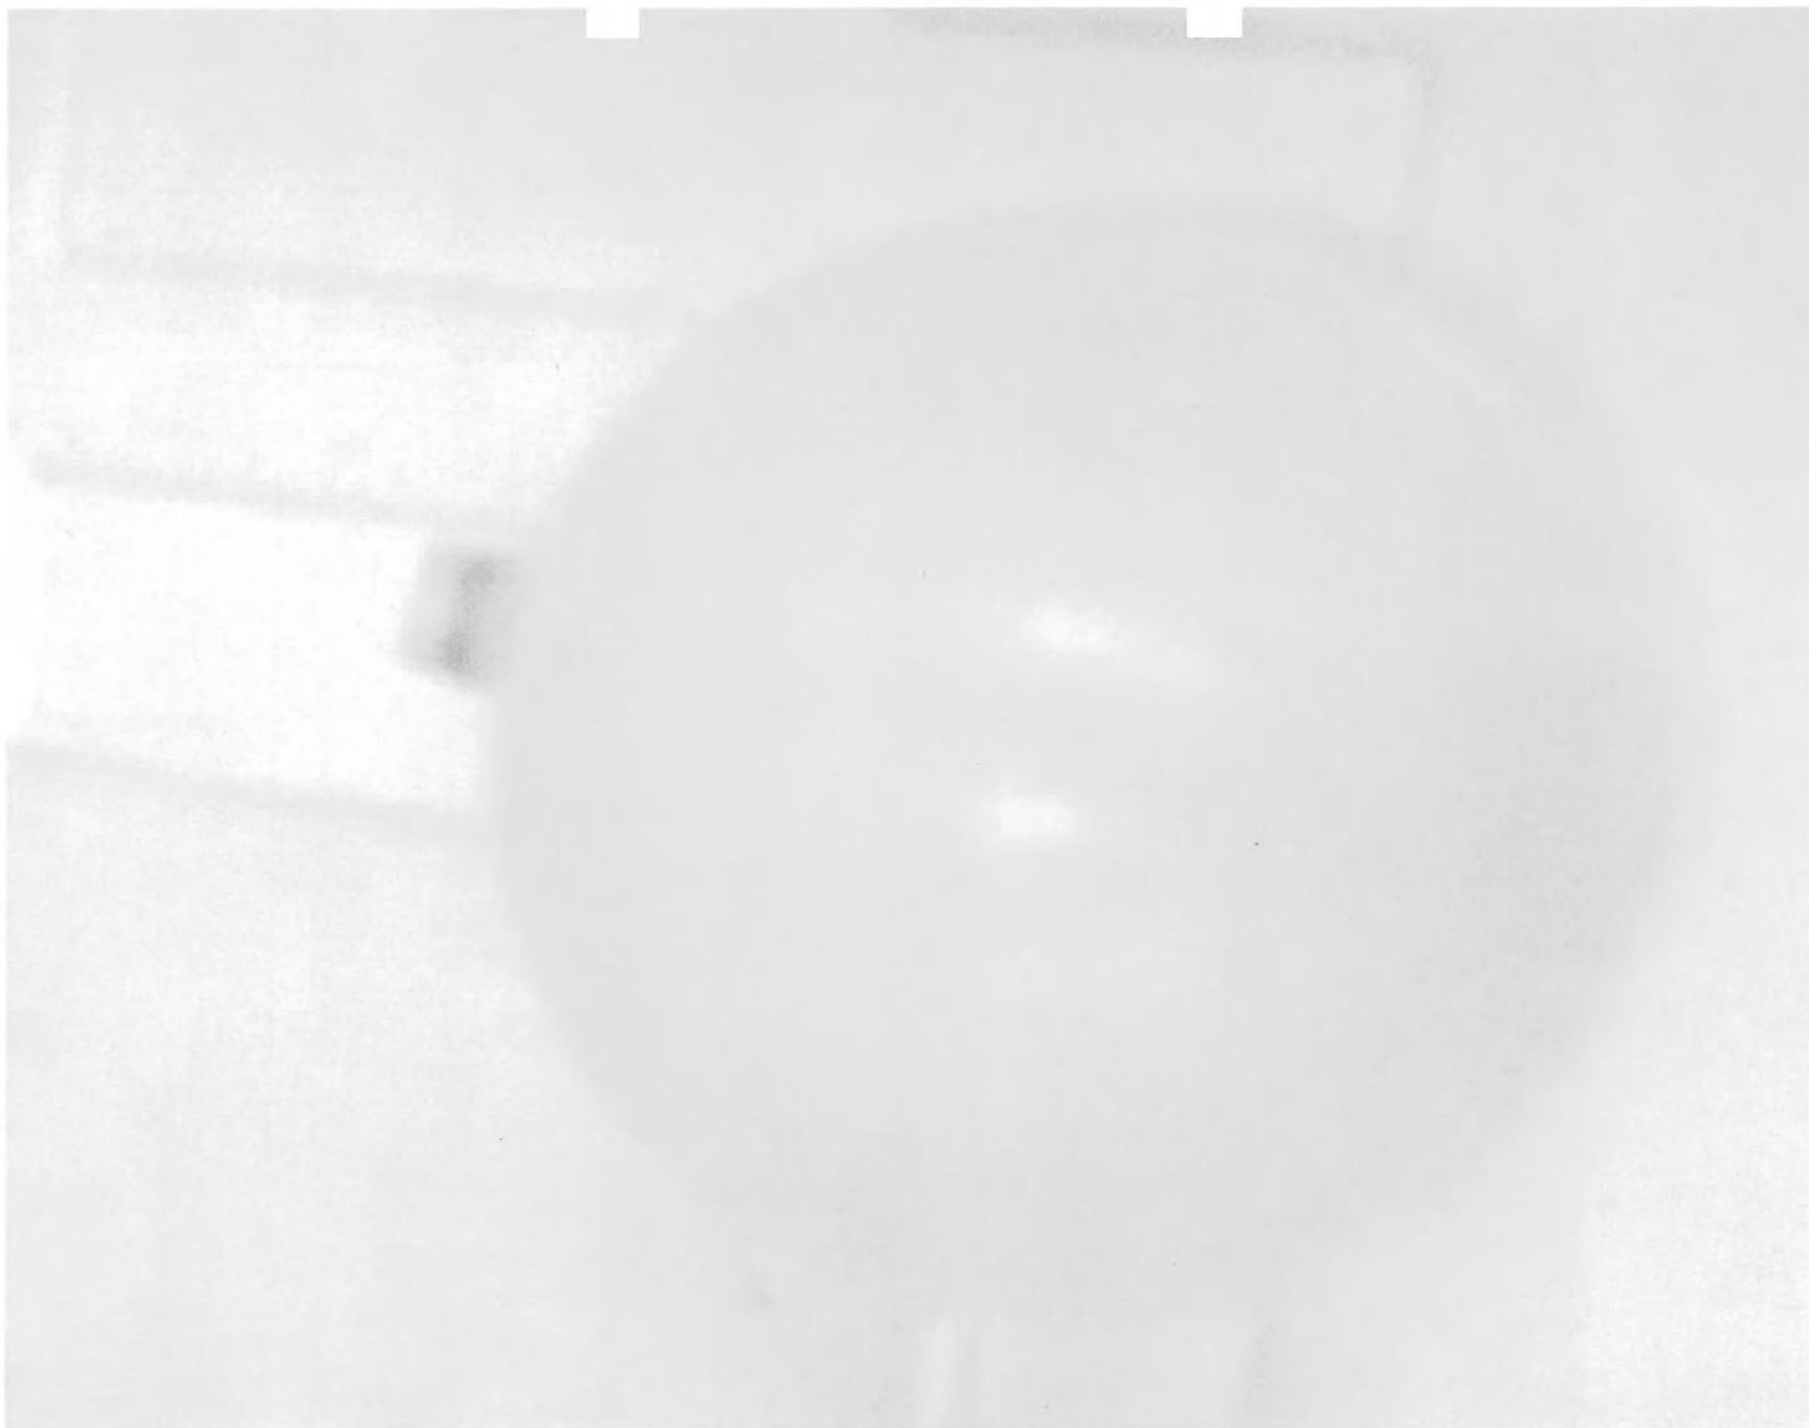


6.7. Протонный сферический фантом.




7. Разделитель кабелей.




7. Разделитель кабелей.

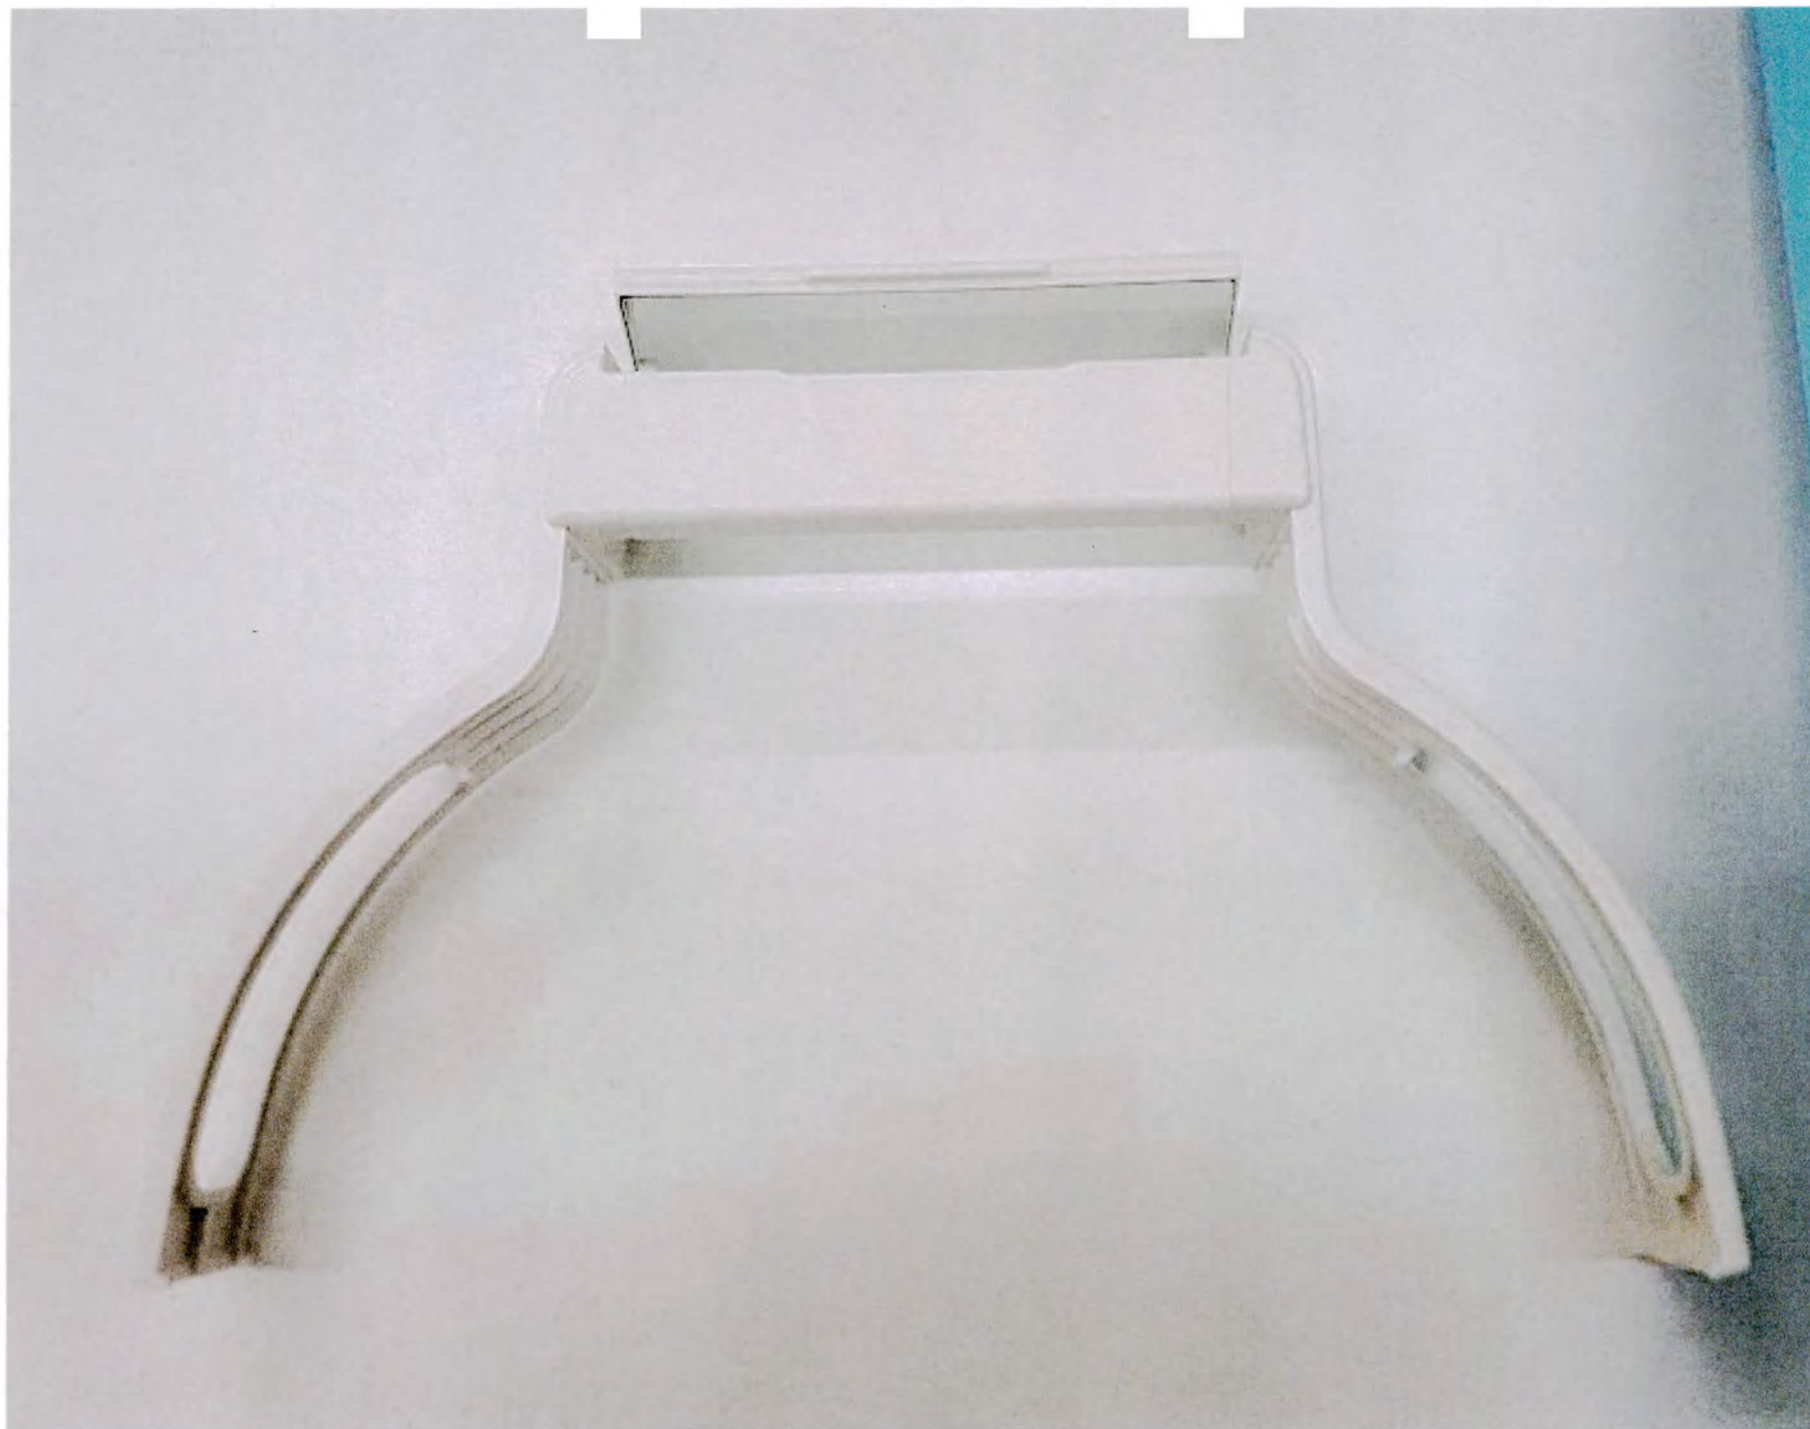

8. Зеркало, вариант исполнения 1.

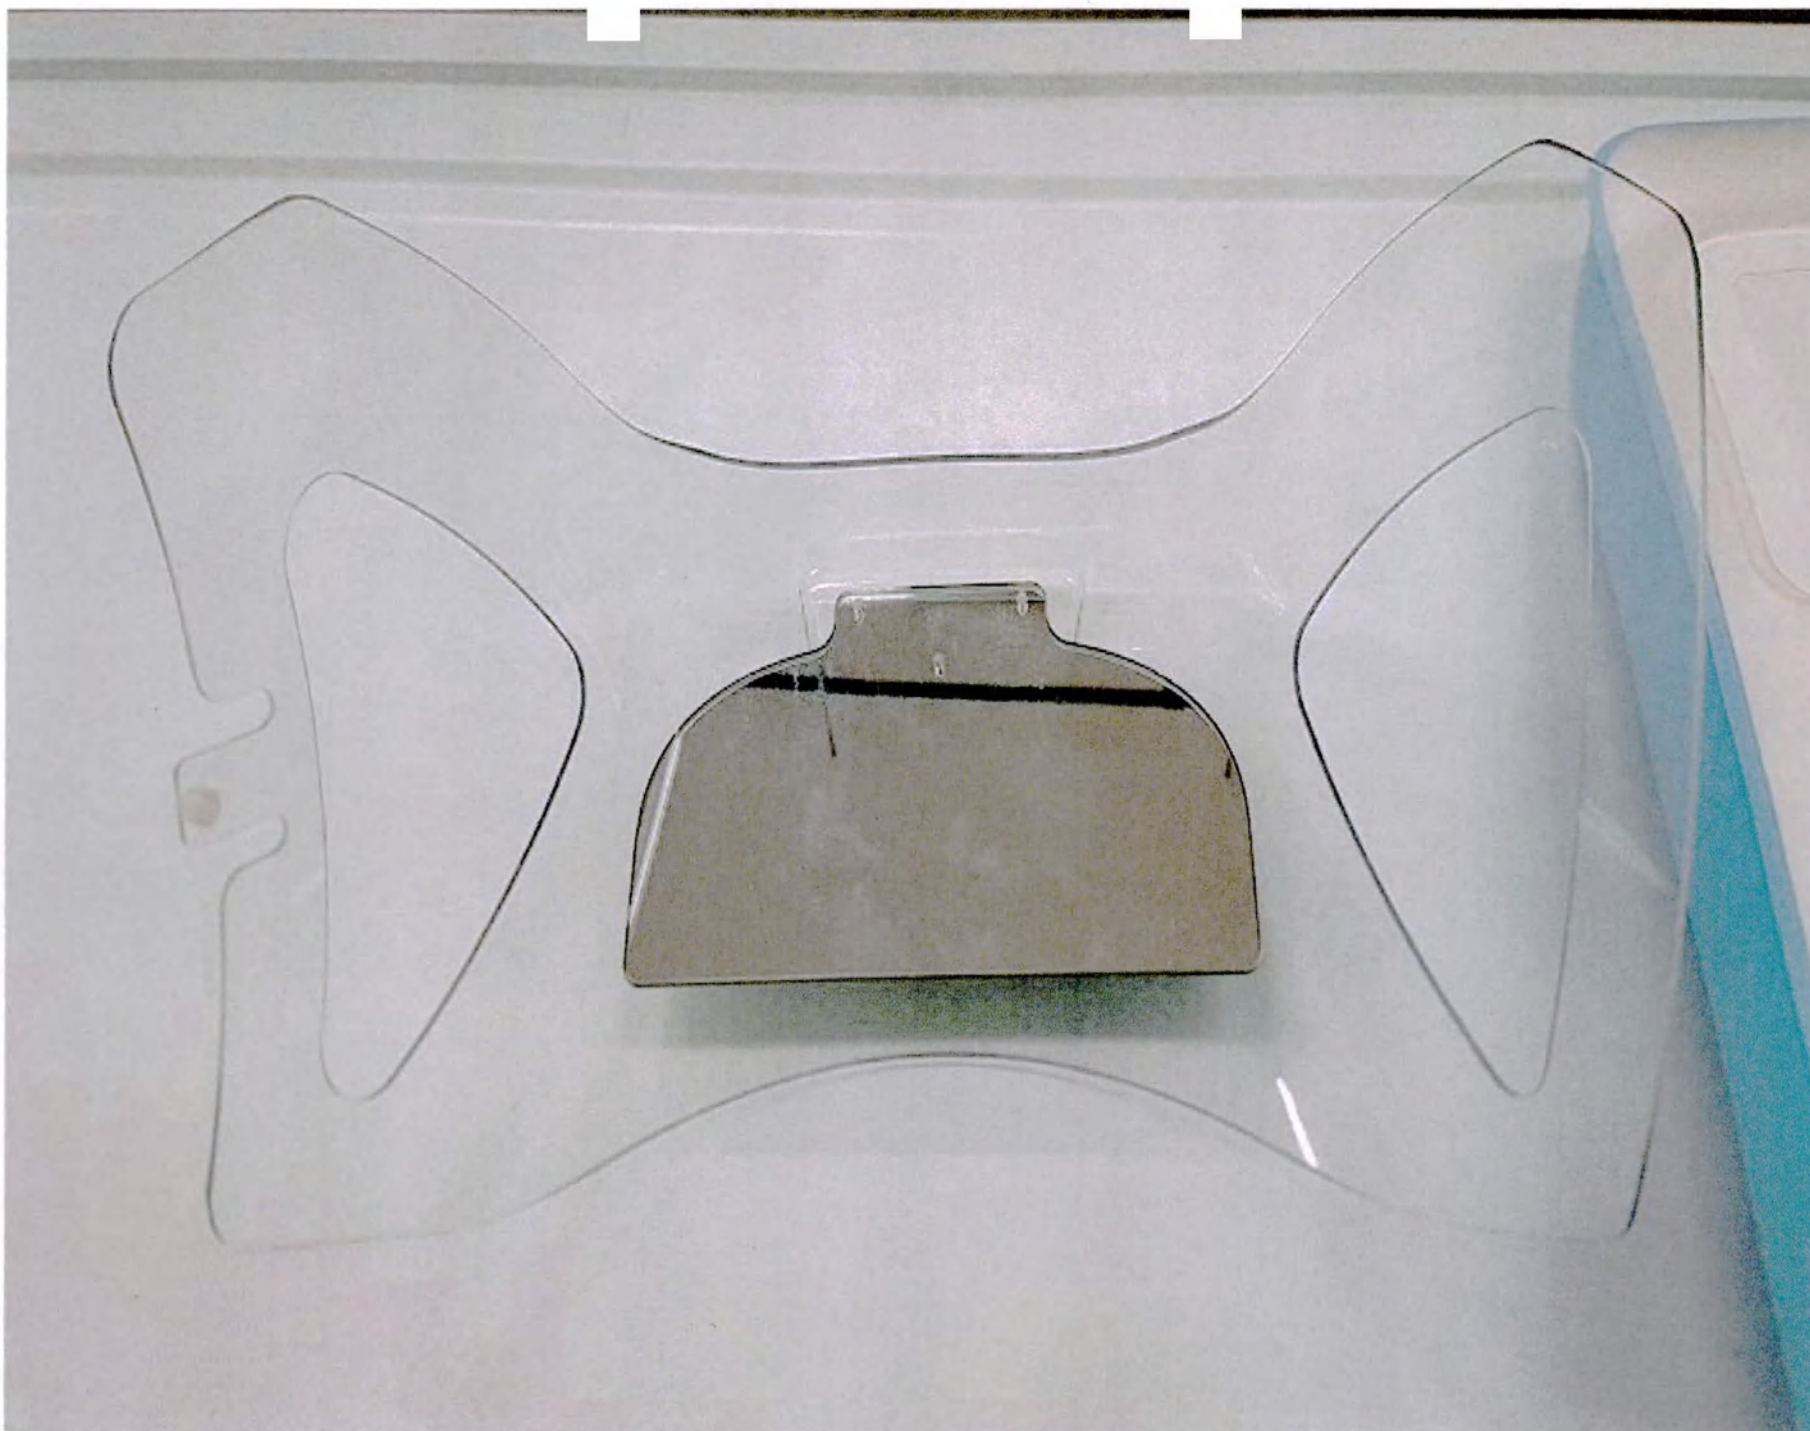

9. Зеркало, вариант исполнения 2.

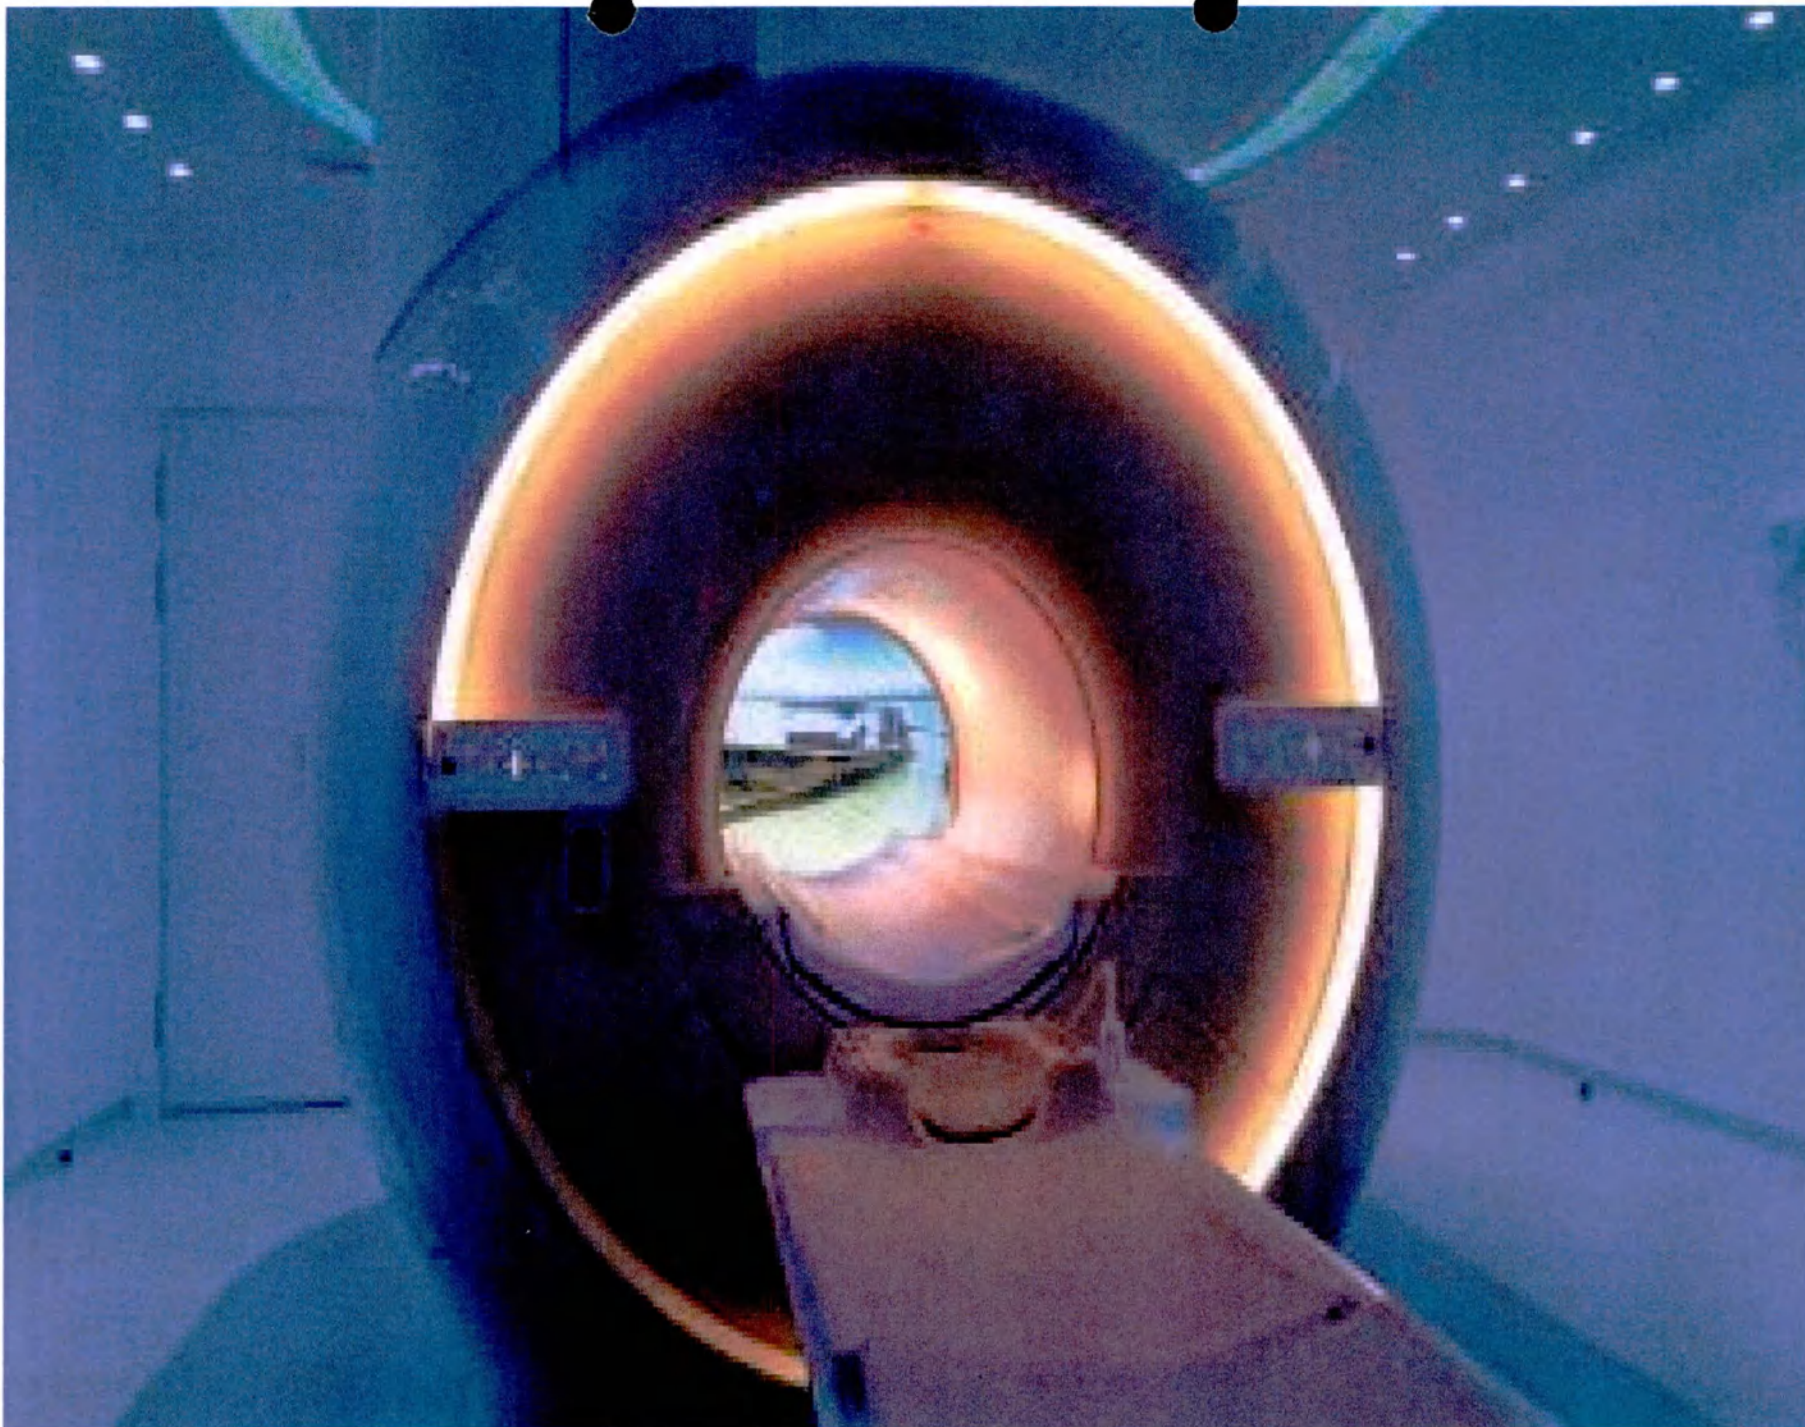

10. Дисплей в помещении для исследований.




11. Специальное немагнитное противопожарное устройство.



12. Система наблюдения за пациентом (камера наблюдения).




12. Система наблюдения за пациентом (интерфейс камеры наблюдения).

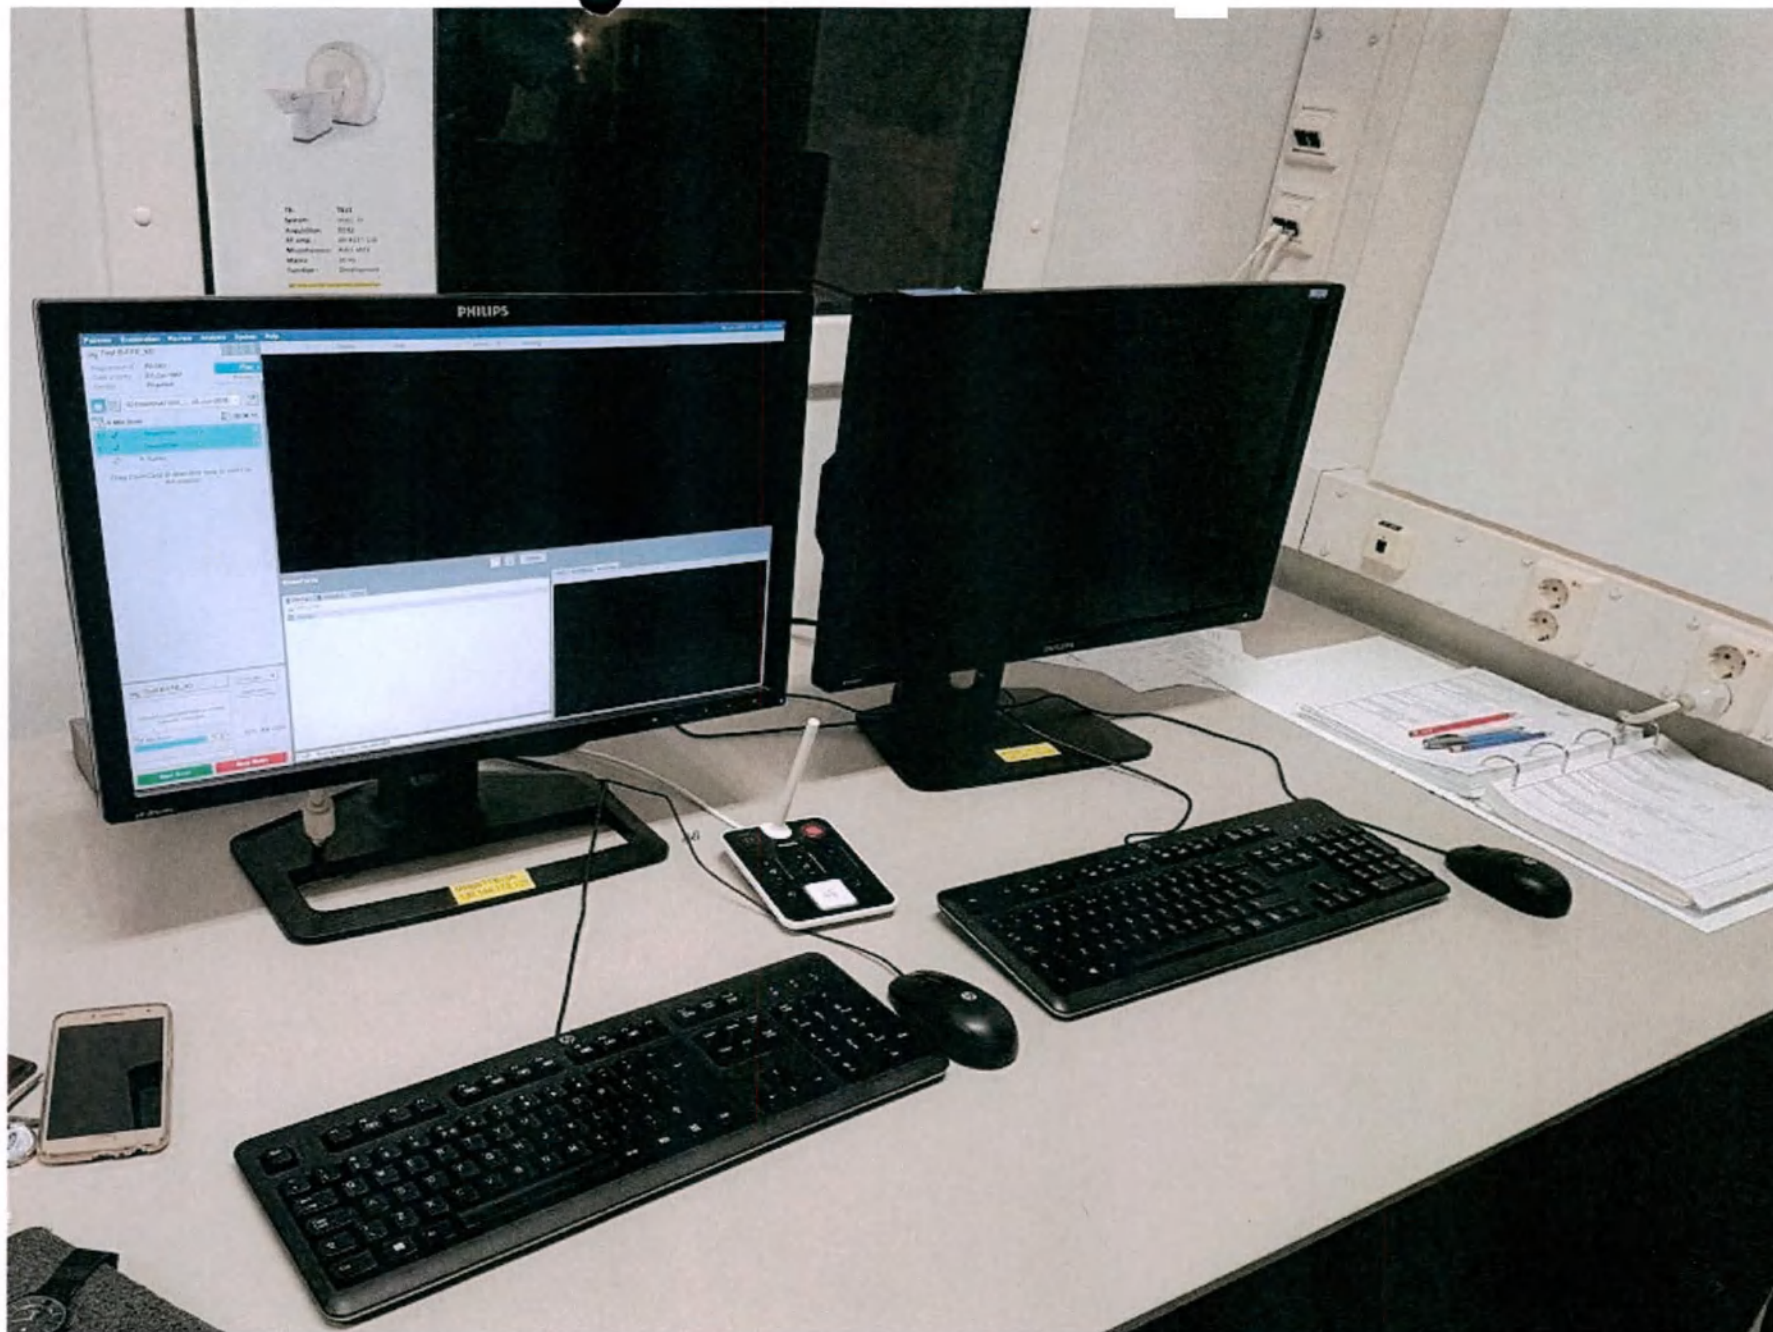

12. Система наблюдения за пациентом. (Монитор системы наблюдения за пациентом - справа).

Маркировка производителя медицинского изделия «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition»


 Philips Magnetic Resonance Equipment	
# INGENIA AMBITION S	ETL CLASSIFIED  Intertek 4000488 Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1, IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6, IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33 Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1
REF 782139	
SN 1234	
 UDI (01) 00884838108639 (21) 1234	
 Philips Medical Systems Nederland B.V. Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands	Производитель "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды. Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands Место производства медицинского изделия: Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями Вариант исполнения: Ingenia Ambition S Номинальный режим работы 3N~220/380V, 50/60Hz, 60kVA 3N~230/400V, 50/60Hz, 60kVA 3~480V, 60Hz, 60kVA
 2024-06-25	Серийный номер: см. на основной маркировке Дата изготовления: см. на основной маркировке Регистрационное удостоверение: № P3H 2019/9428 Предупреждения и знаки опасности: 
3N~220/380V, 50/60Hz, 60kVA 3N~230/400V, 50/60Hz, 60kVA 3~480V, 60Hz, 60kVA	



0344



www.philips.com/ifu



MD

1. Маркировка производителя с наклеенной русскоязычной маркировкой для варианта исполнения «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S»



Philips Magnetic Resonance Equipment

INGENIA AMBITION X

REF **782138**

SN **1234**



UDI (01) 00884838108622

(21) 1234



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



2024-06-25

3N~220/380V, 50/60Hz, 80kVA

3N~230/400V, 50/60Hz, 80kVA

3~480V, 60Hz, 80kVA

ETL CLASSIFIED



Intertek

4000488

Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1,
IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6,
IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33
Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1

Производитель "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды.

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями.

Вариант исполнения: Ingenia Ambition X

Номинальный режим работы **3N~220/380V, 50/60Hz, 80kVA**

3N~230/400V, 50/60Hz, 80kVA

3~480V, 60Hz, 80kVA

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2019/9428

Предупреждения и знаки опасности:



CE 0344



www.philips.com/ifu



MD

2. Маркировка производителя с наклеенной русскоязычной маркировкой для варианта исполнения
«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X»

Производитель: "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды,
Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями

Вариант исполнения: Ingenia Ambition S

Номинальный режим работы **3N~220/380V, 50/60Hz, 60kVA**

3N~230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~480V, 60Hz, 60kVA

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № PЗН 2019/9428

Предупреждения и знаки опасности:



3. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения
«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S», место производства Нидерланды

Производитель: "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды,

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями

Вариант исполнения: Ingenia Ambition X

Номинальный режим работы **3N~220/380V, 50/60Hz, 80kVA**

3N~230/400V, 50/60Hz, 80kVA

3~480V, 60Hz, 80kVA

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № P3H 2019/9428

Предупреждения и знаки опасности: 

4. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения
«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X», место производства Нидерланды

Производитель: "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды, Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., No. 258, ZhongYuan Road, Suzhou Industrial Park 215024 Suzhou, Jiangsu Province, People's Republic of China

Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии Ingenia
Ambition с принадлежностями

Вариант исполнения: Ingenia Ambition X

Номинальный режим работы 3N~220/380V, 50/60Hz, 80kVA
3N~230/400V, 50/60Hz, 80kVA
3~480V, 60Hz, 80kVA

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № PЗН 2019/9428

Предупреждения и знаки опасности: 

6. Макет русскоязычной маркировки для варианта исполнения
«Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X», место производства Китай



7. Маркировка магнита (шильд) для вариантов исполнения «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S» и «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X», место производства Нидерланды



8. Маркировка магнита (шильд) для вариантов исполнения «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S» и «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X», место производства Китай.

Упаковка медицинского изделия (распространяется на варианты исполнения «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition S» и «Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition X»)



1. Упаковка магнита



2. Упаковка Стола пациента



3. Упаковка Градиентного усилителя



4. Упаковка Шкафа DACC



5. Пример упаковки РЧ-катушек



6. Пример упаковки РЧ-катушек

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 167 листа (ов)

ООО «ФИЛИПС»

