

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МиниМед»




В.Р. Азбукин

**Фотографические изображения
медицинского изделия**


**«Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
по ТУ 32.50.50-039-29508133-2023»**

2023г.


Пробирка – поплавок микробиологическая: ПМ-5, ПМ-10

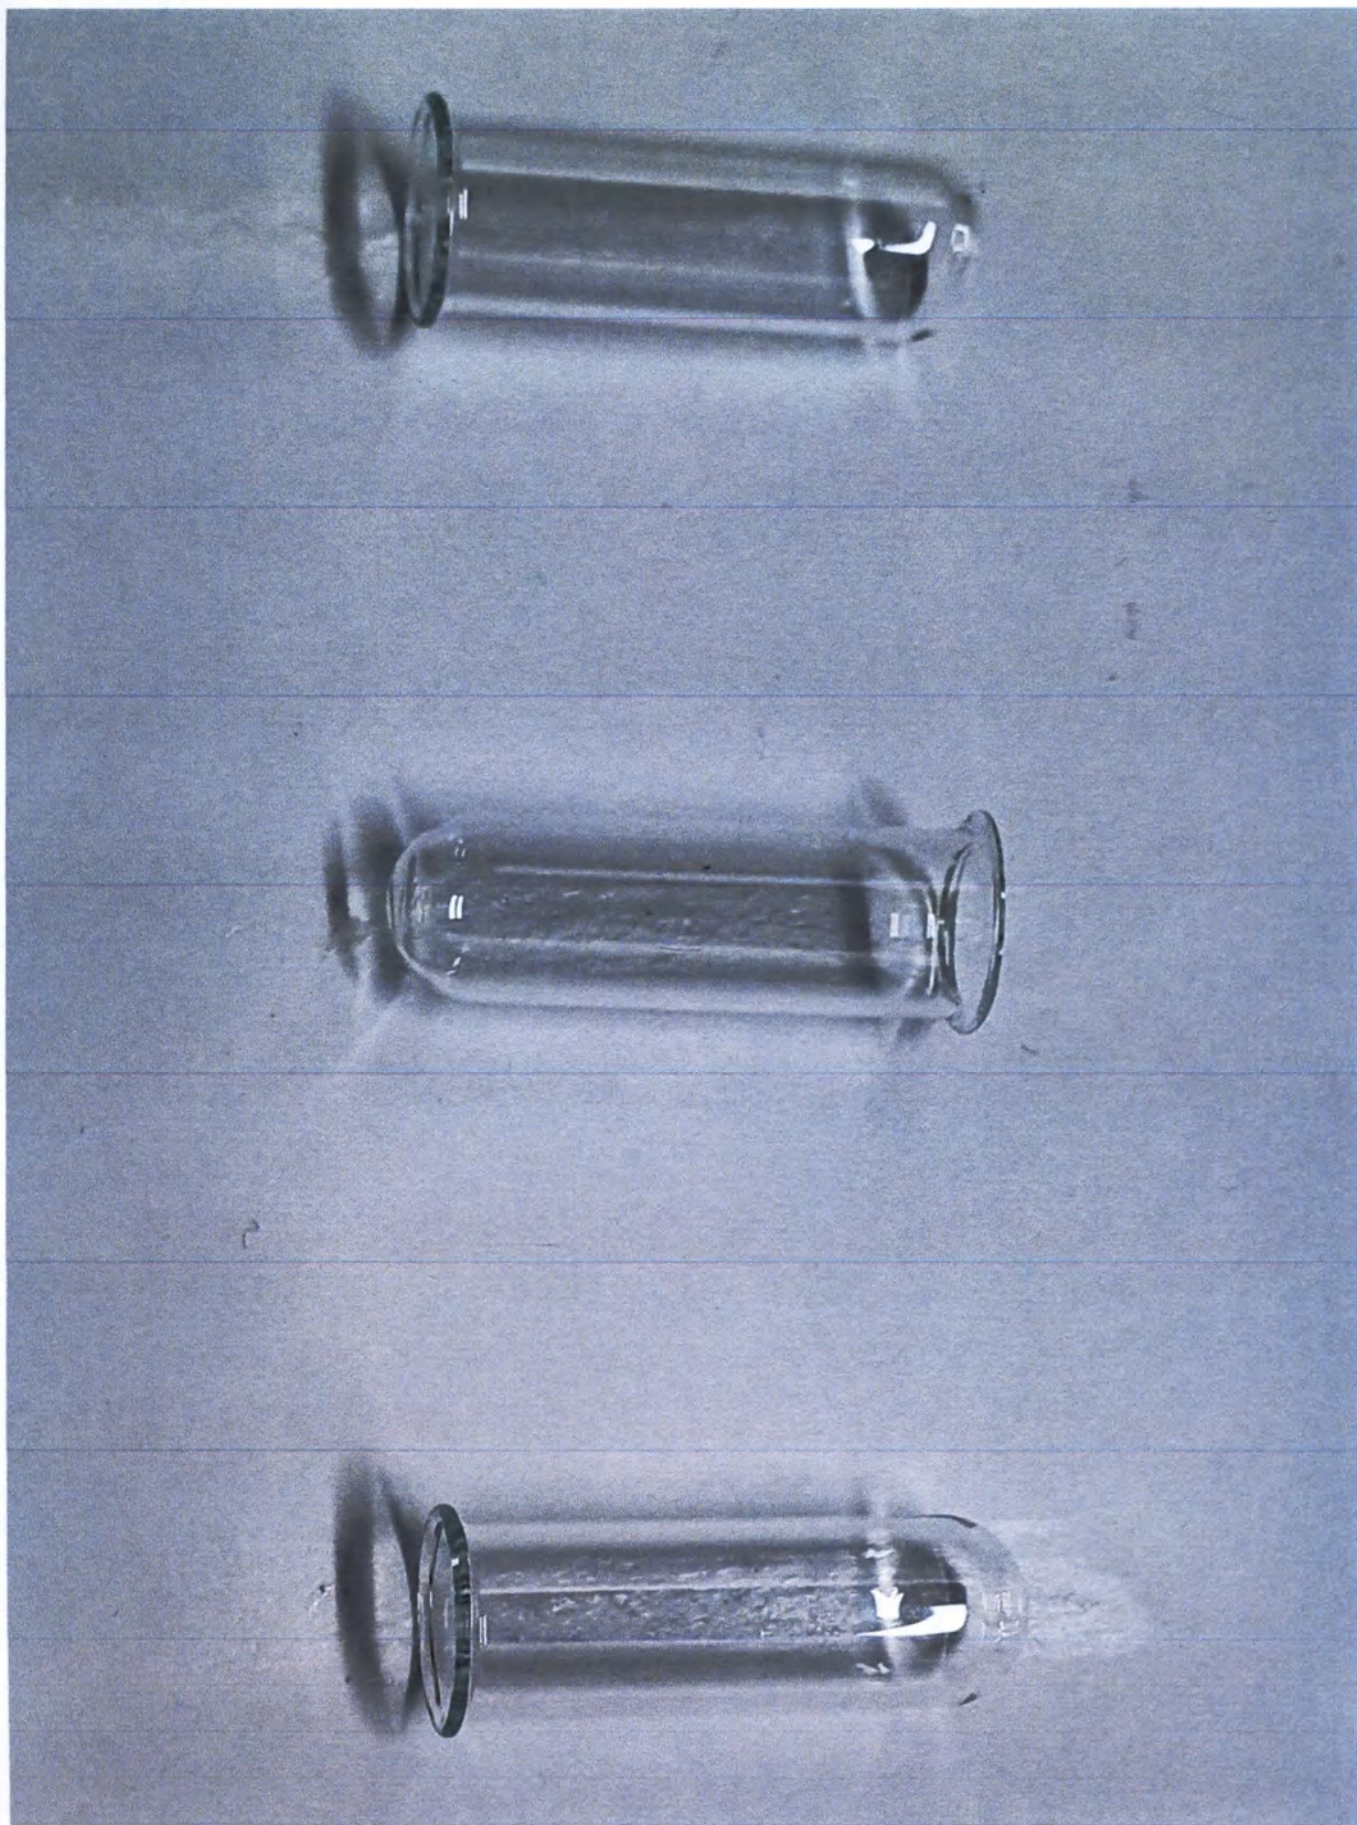


Уленгута: ПУ-40, ПУ-60, ПУ-90, ПУ-120

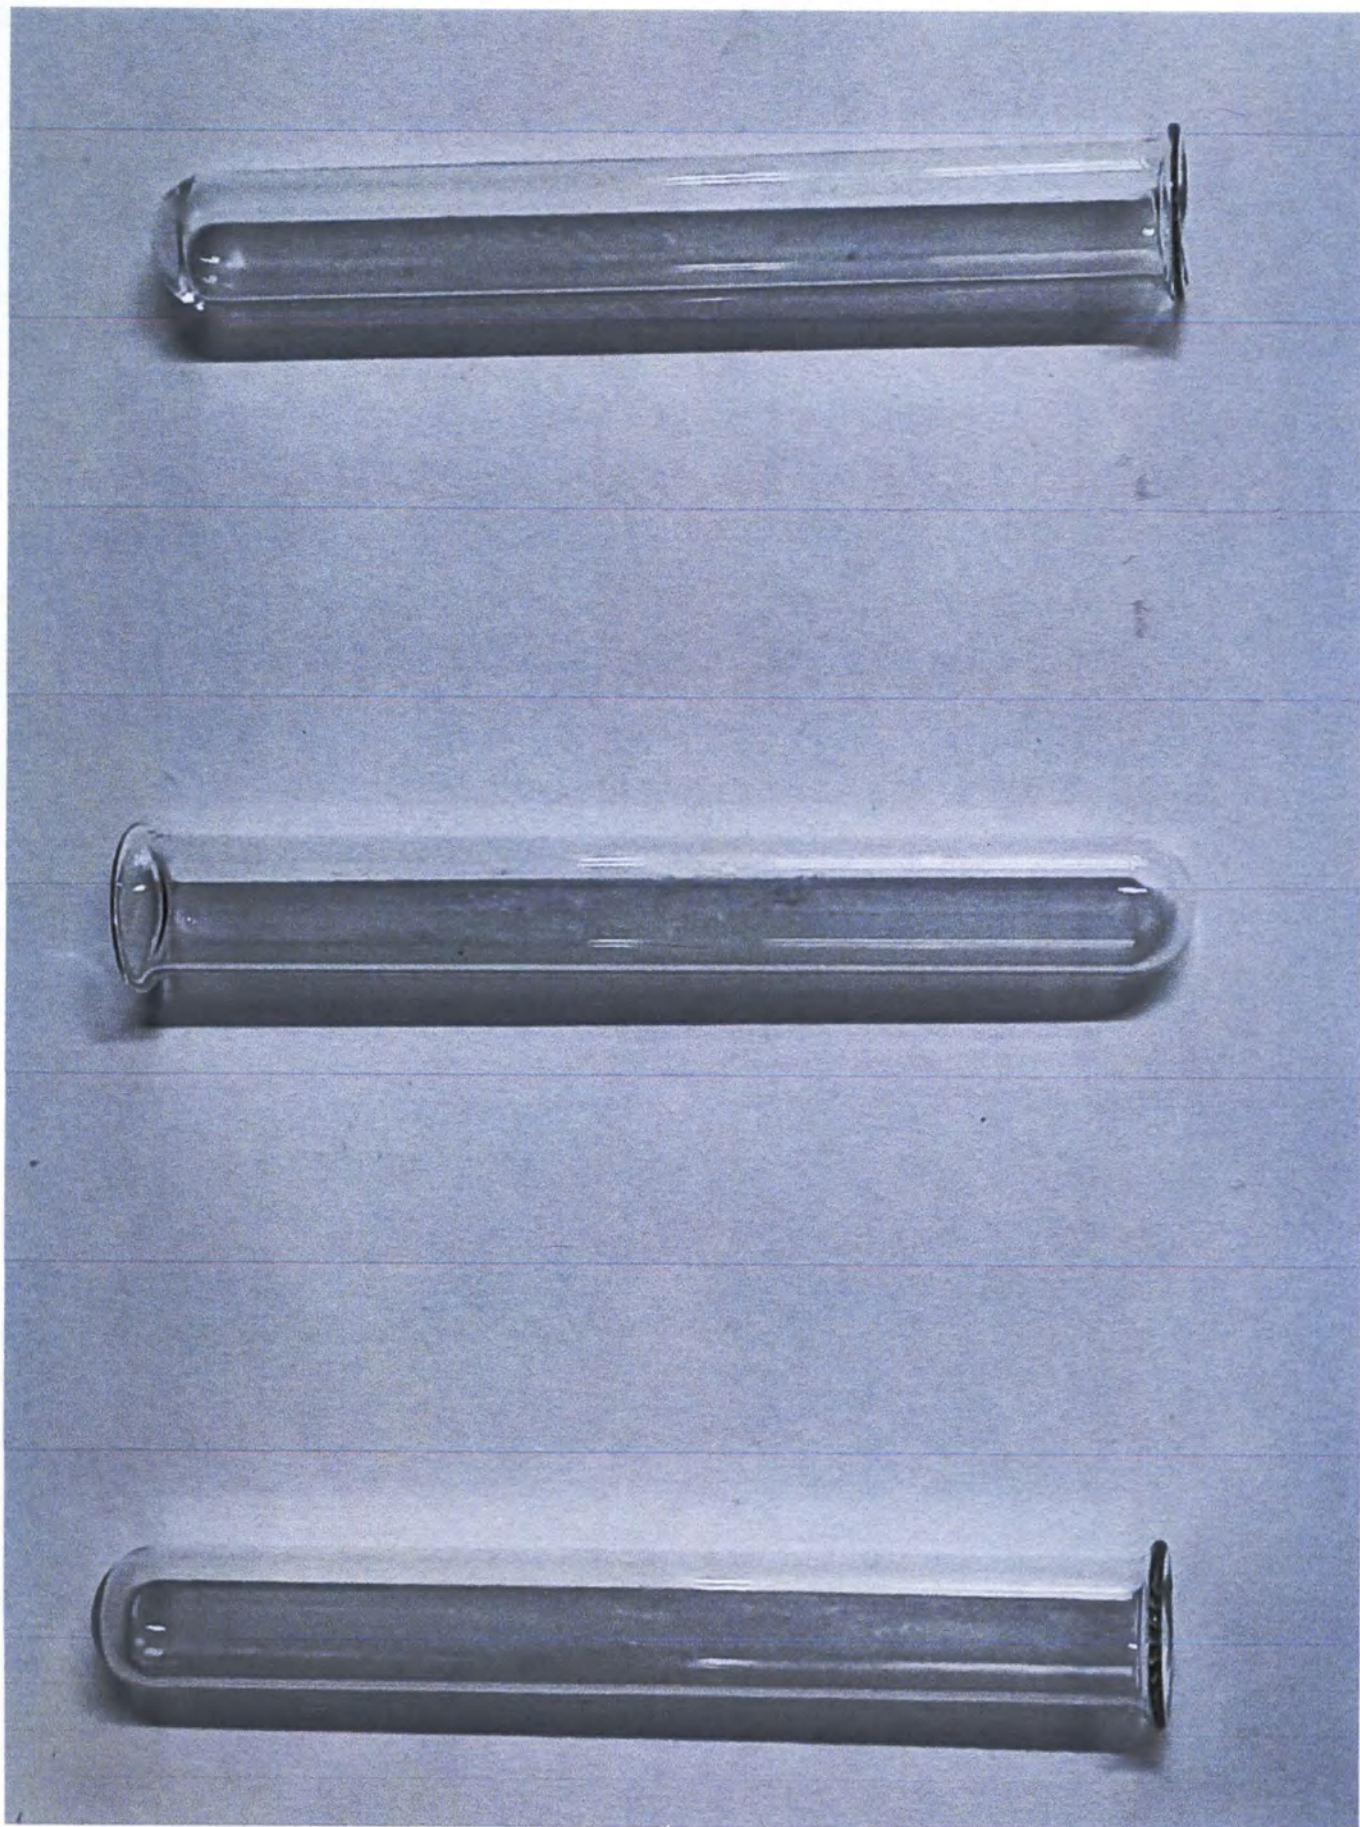


Биологическая (Вассермана): ПБ2-14x100

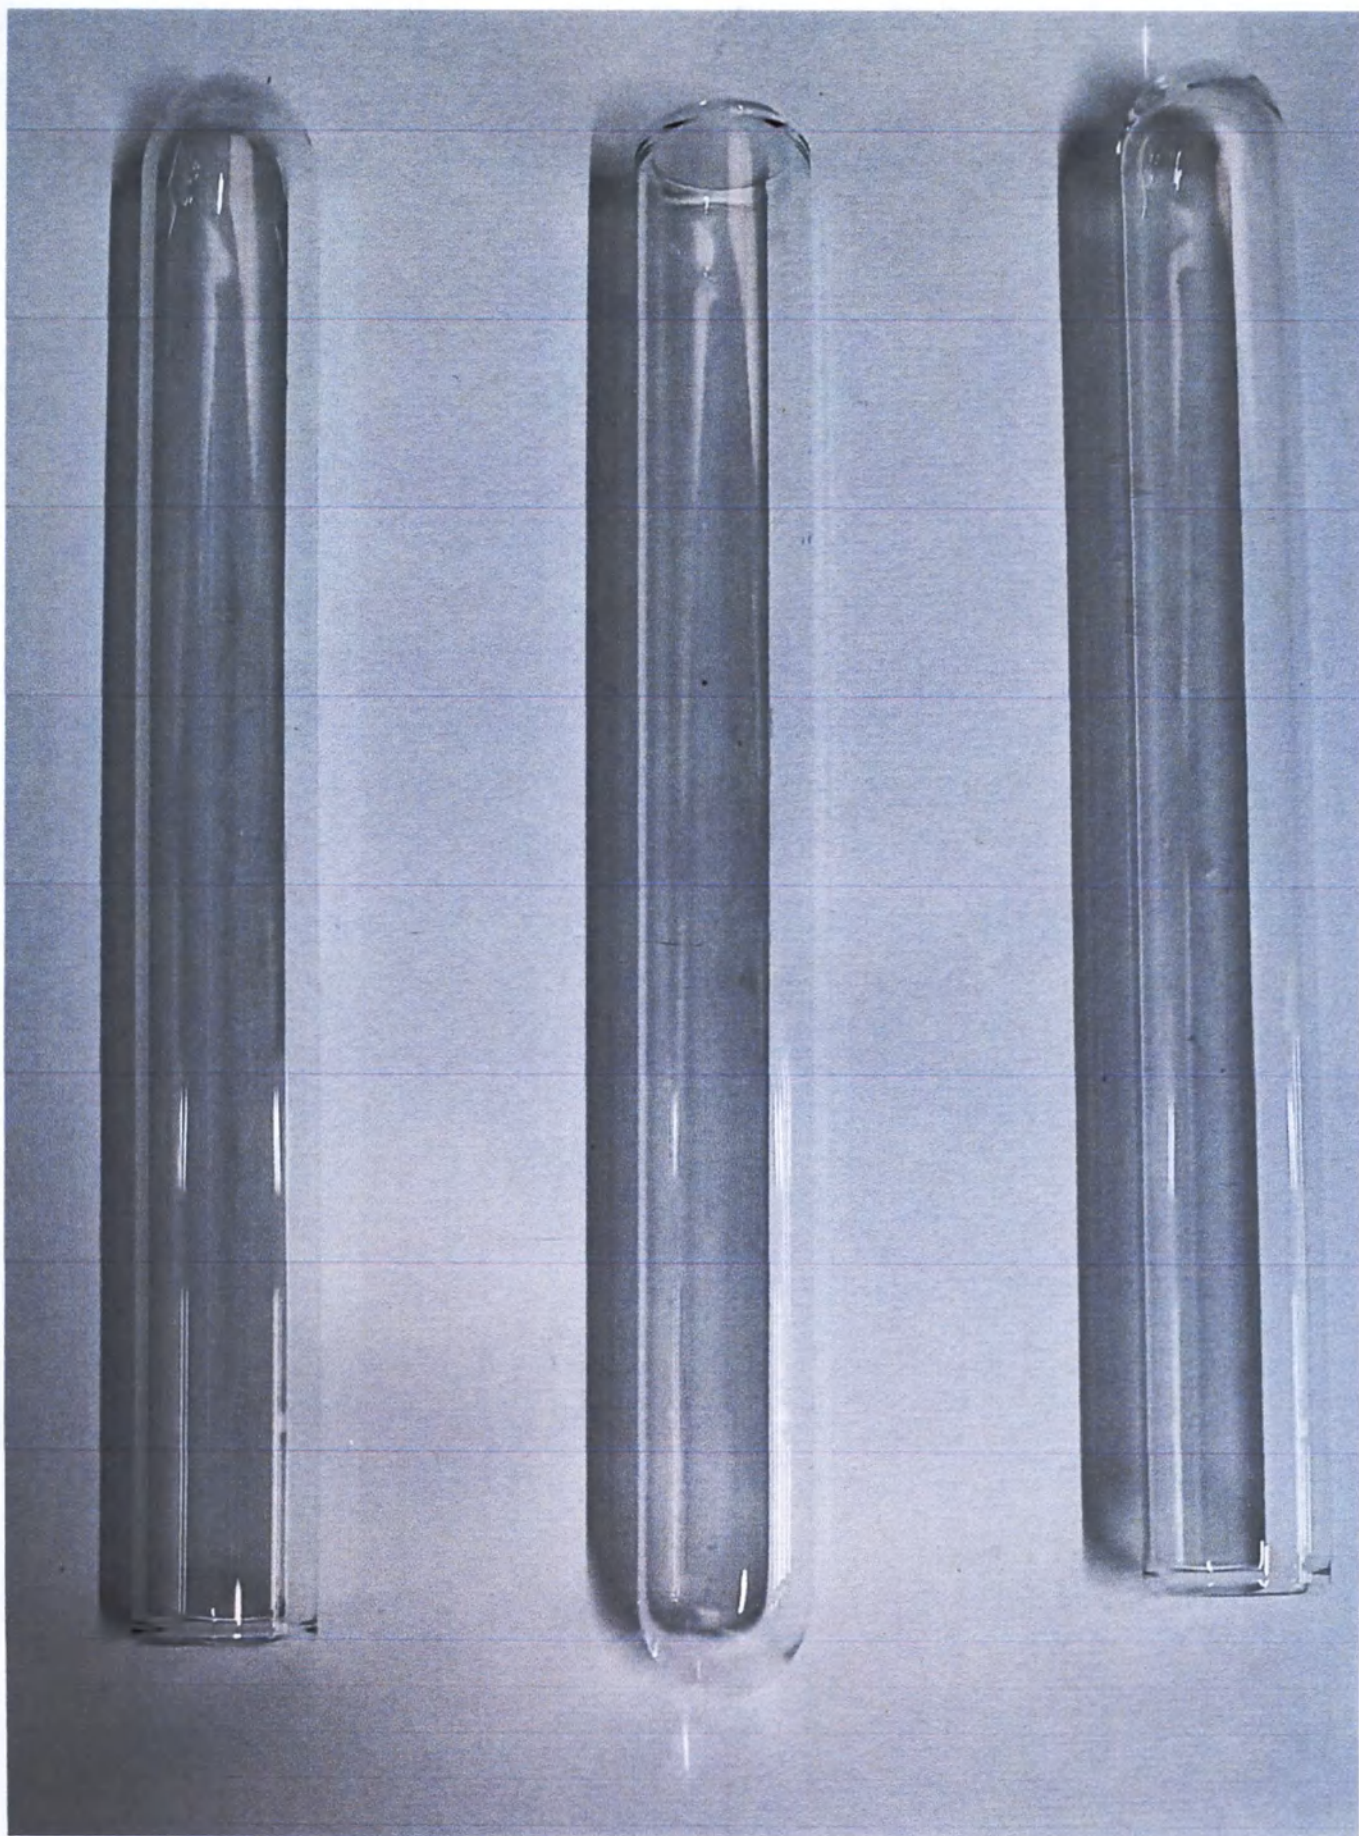

Биологическая: ПБ2-14x120, ПБ2-16x150, ПБ2-21x200

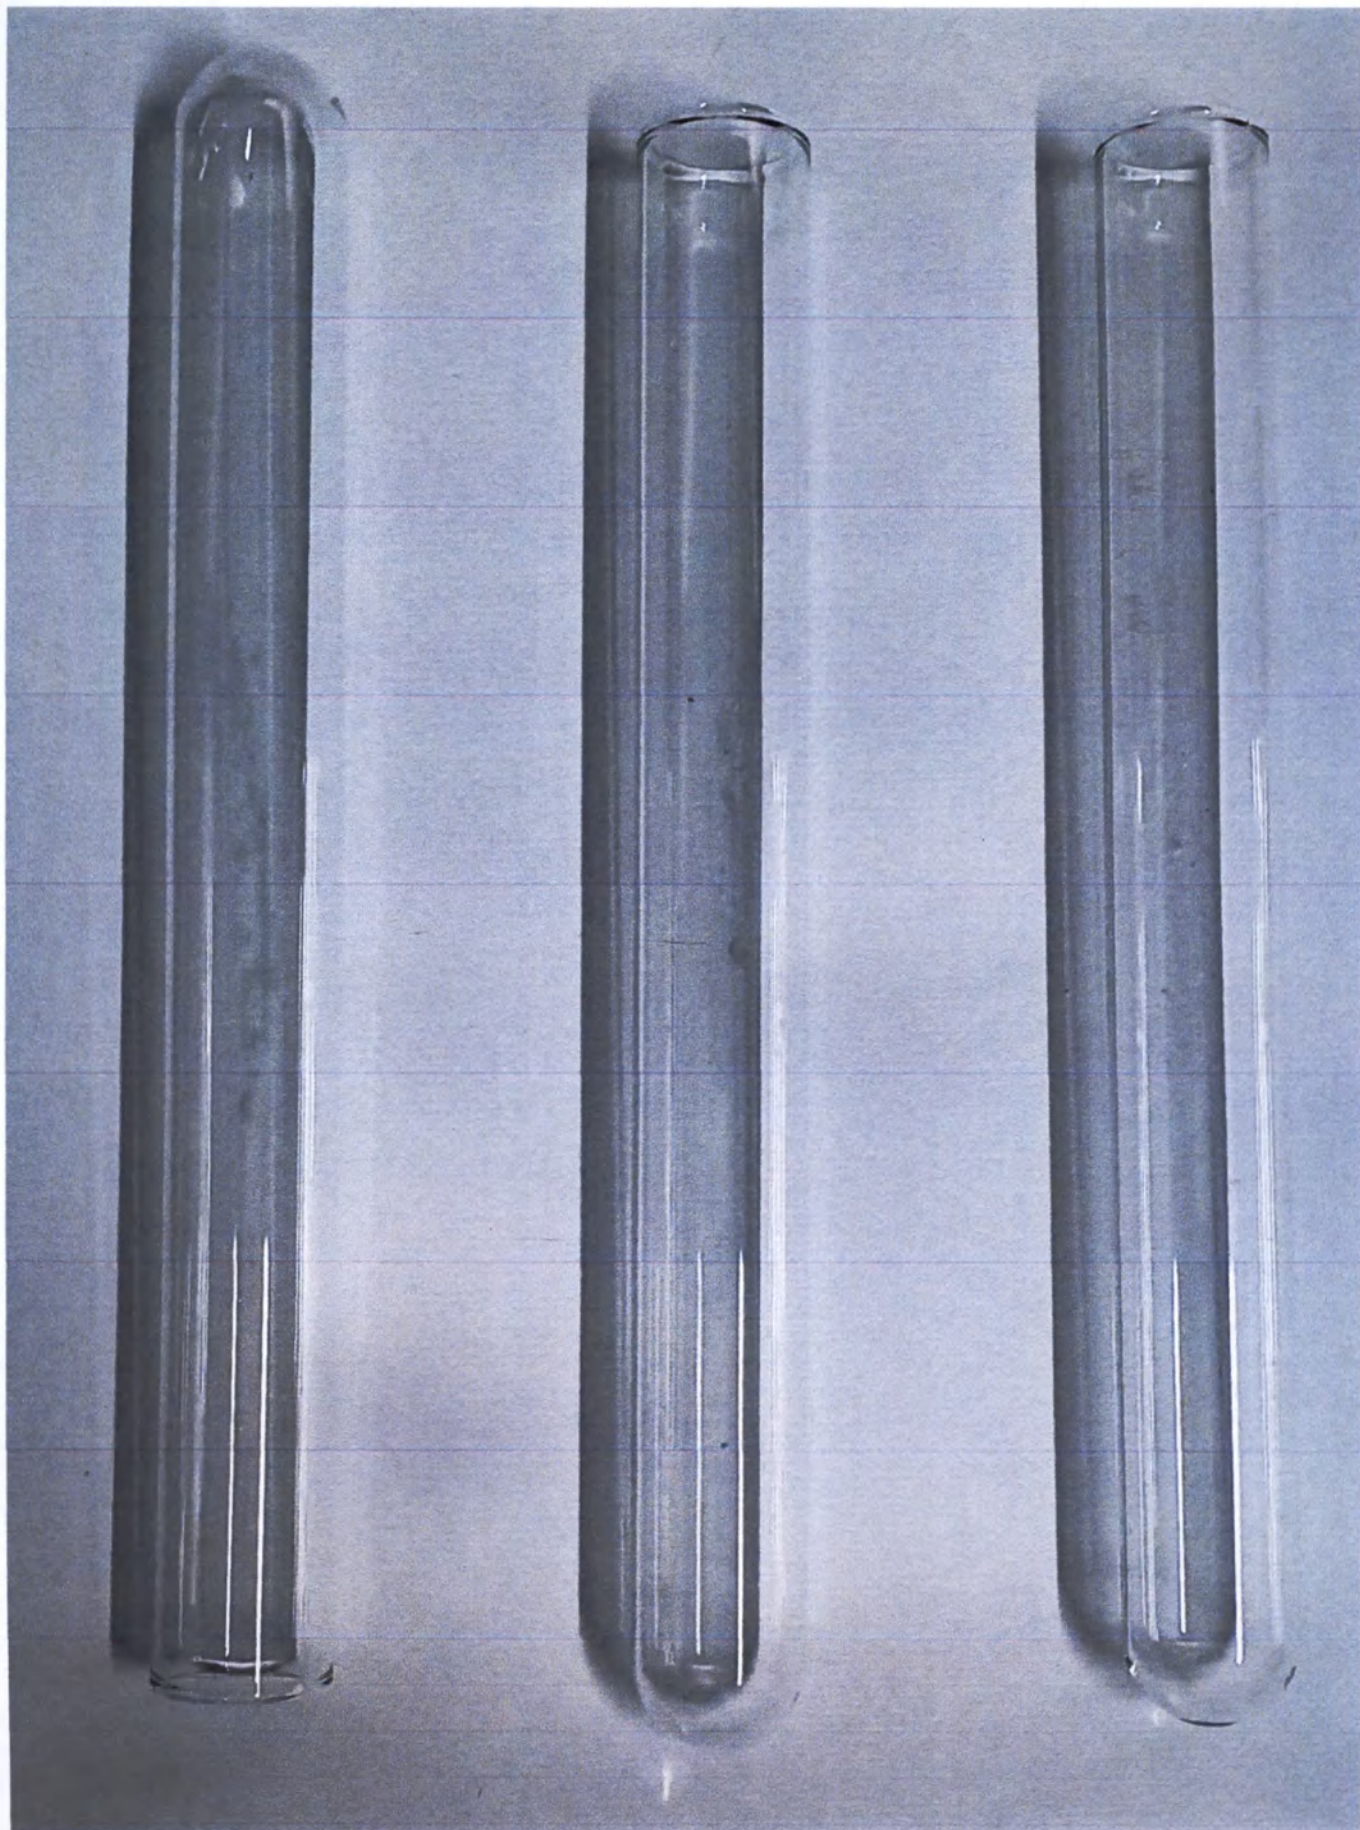


Химическая: ПХ1-14х120, ПХ1-16х150, ПХ1-21х200

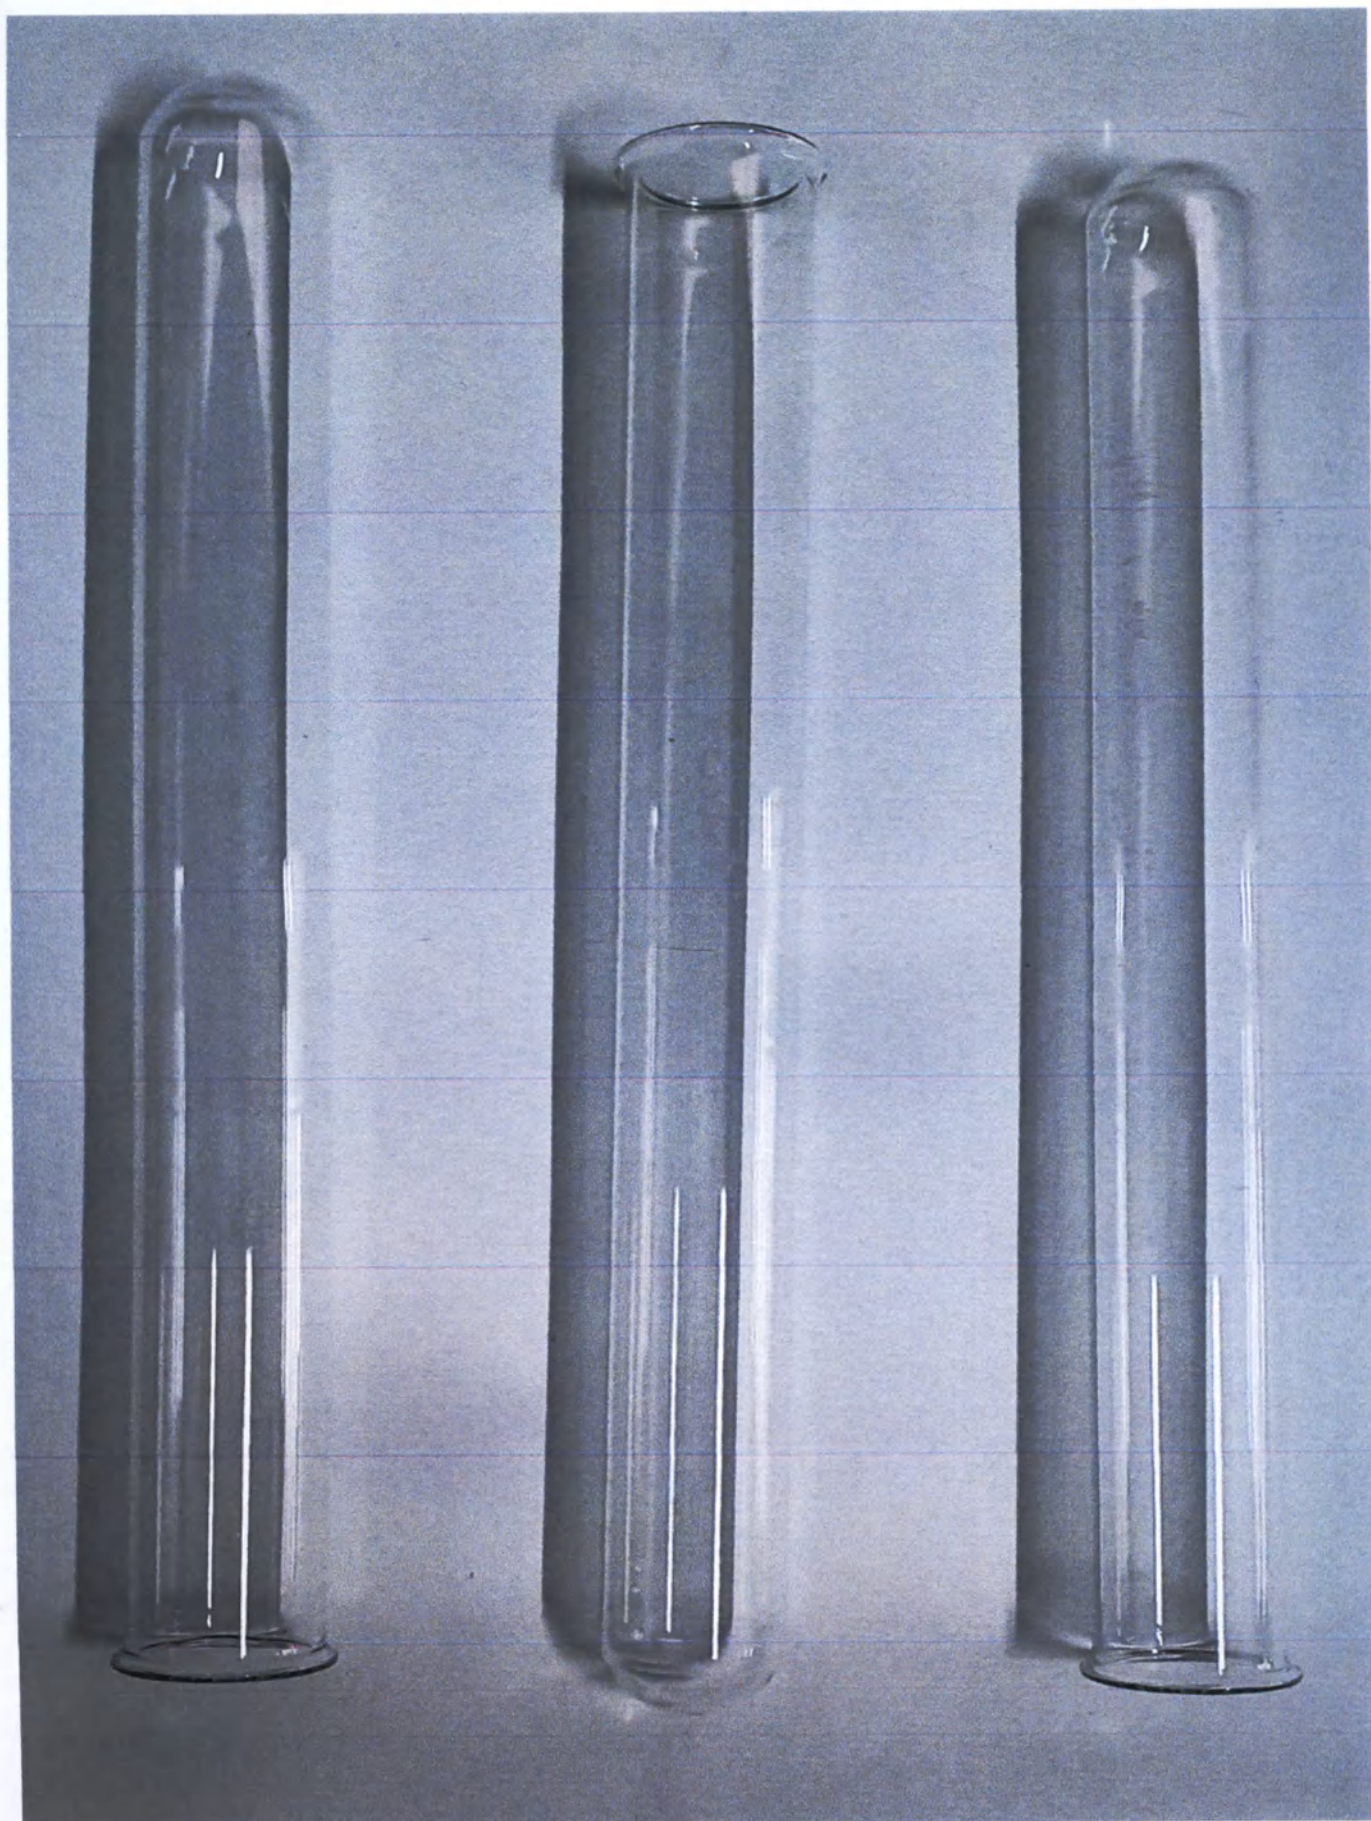


Биохимическая: ПБХ2-16х120




Центрифужная неградуированная, ПЦНГ: П-1-10

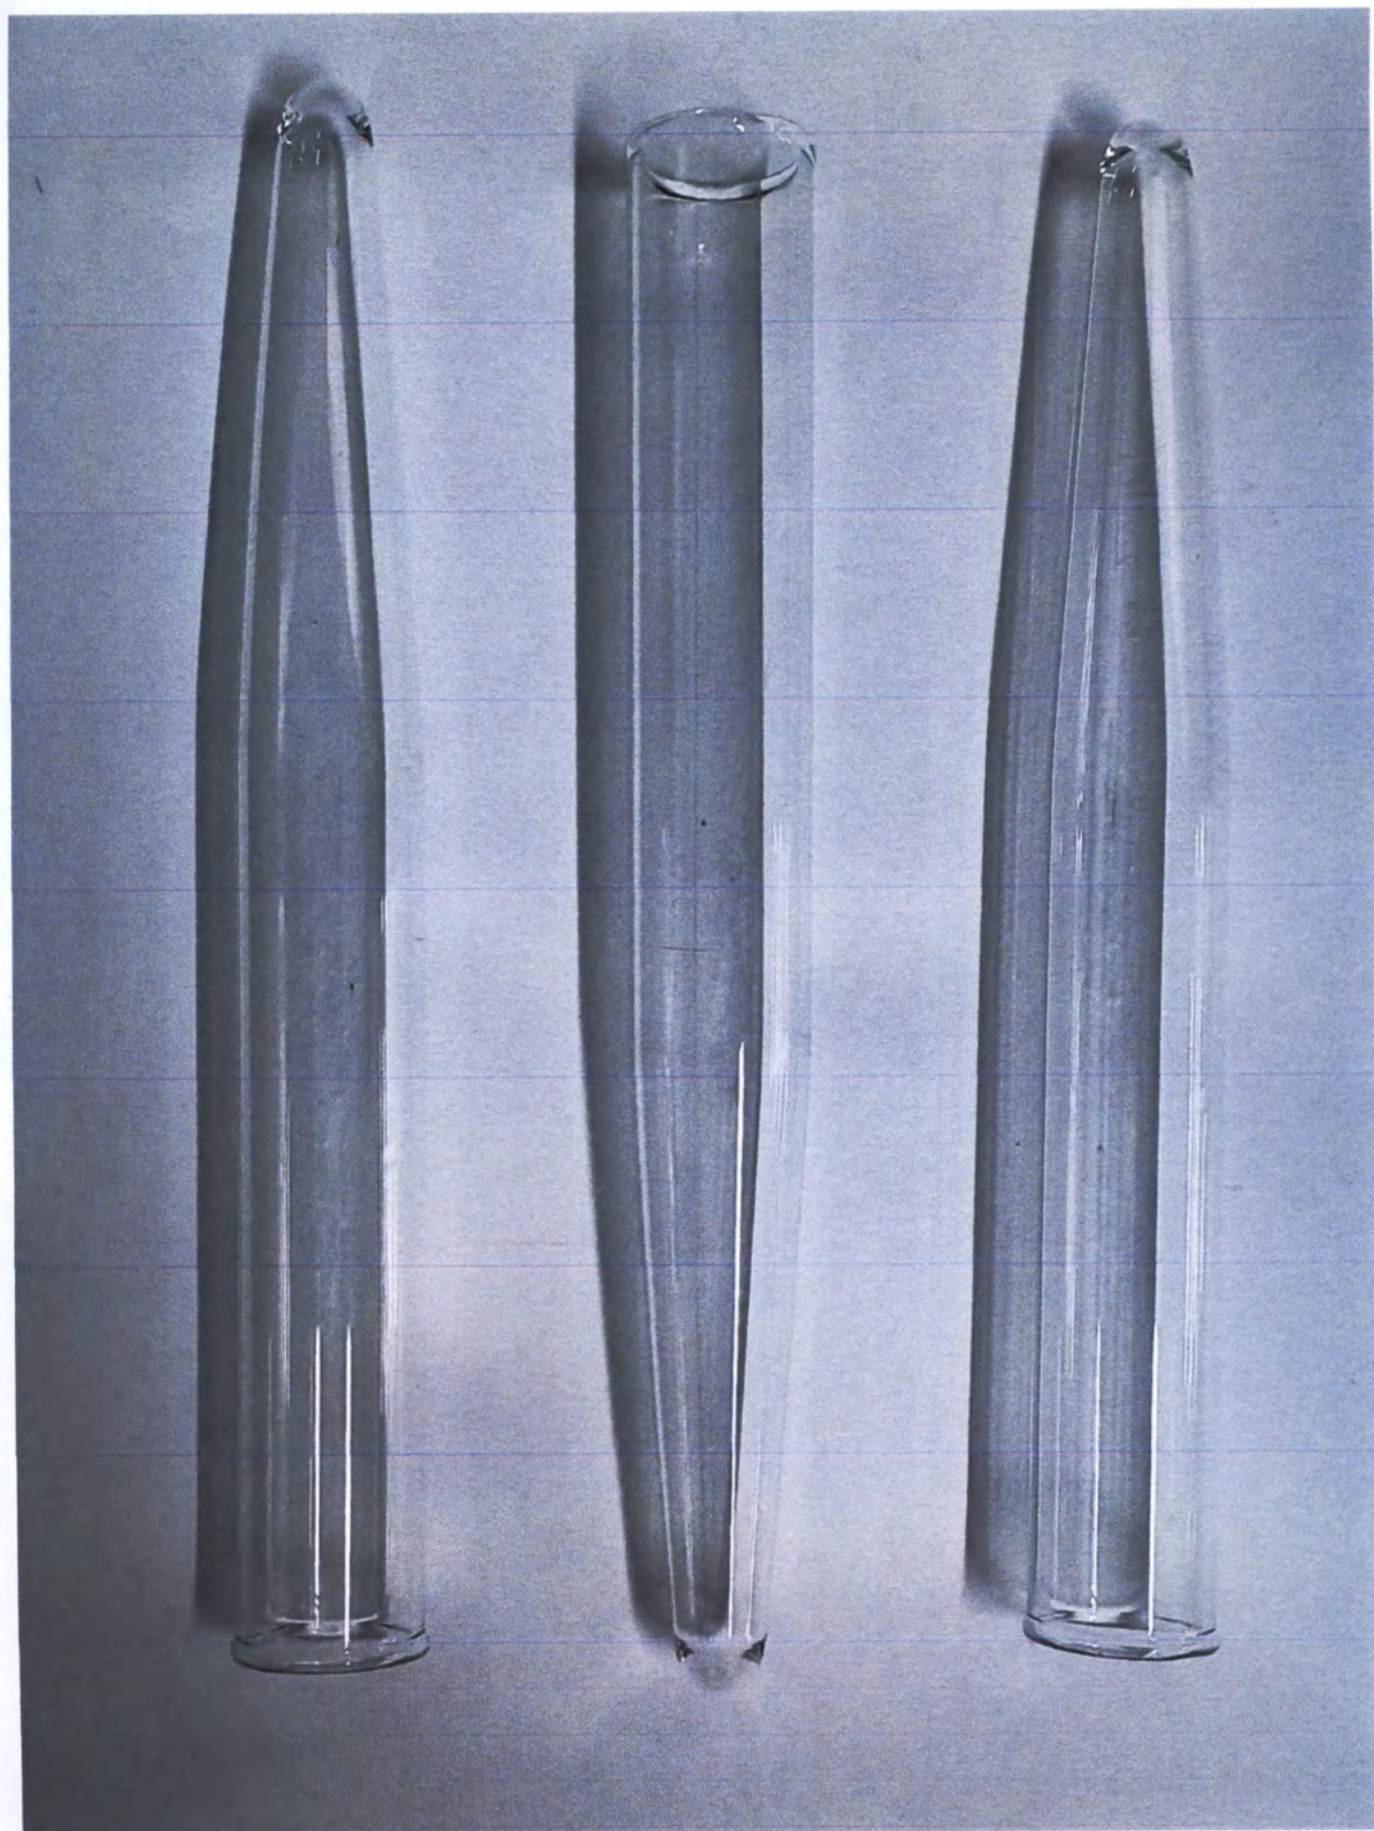


Центрифужная градуированная, ПЦГ: П-1-10-0,1

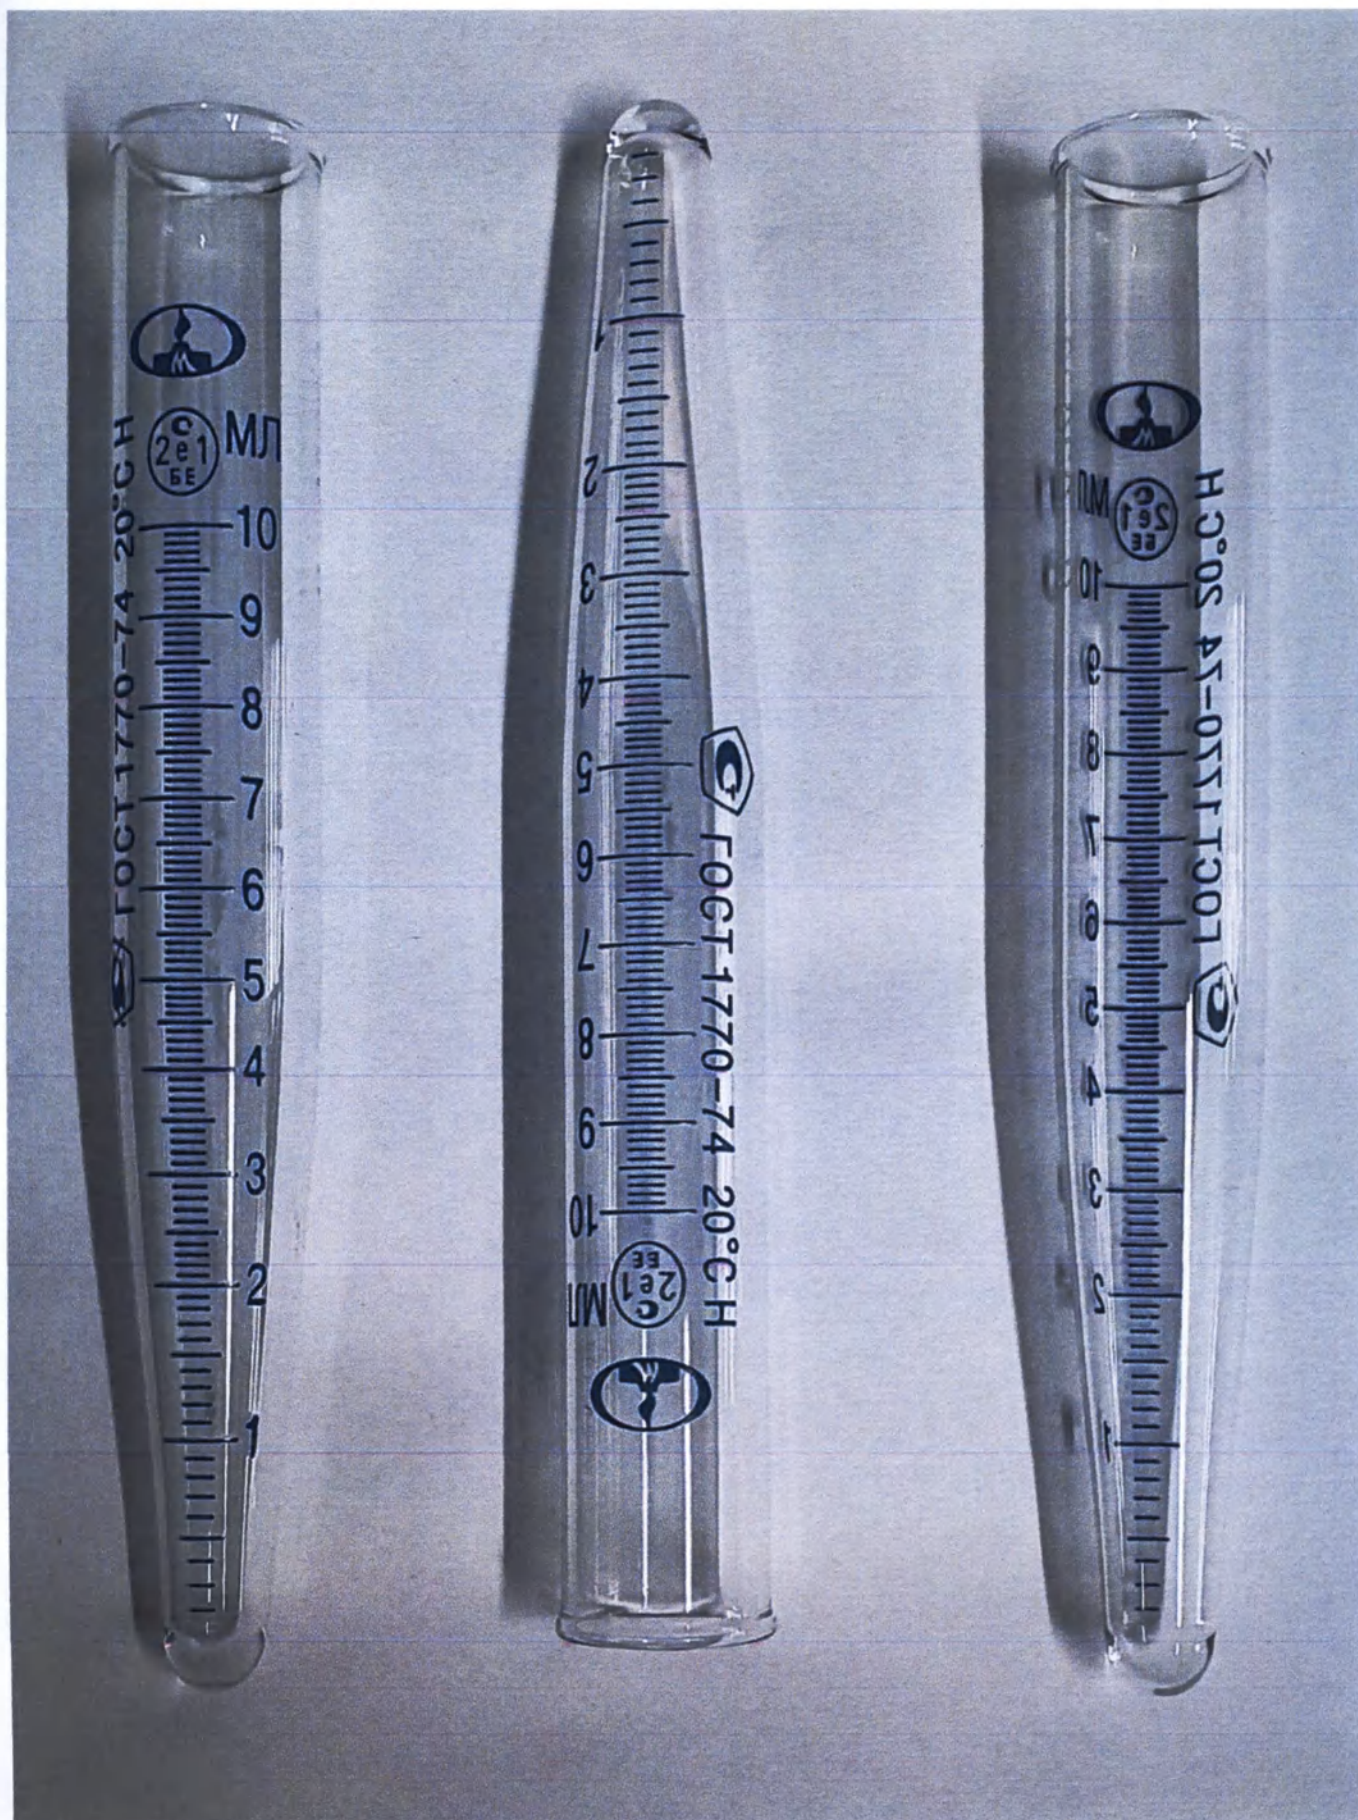


Центрифужная градуированная, ПЦГ: П-1-10-0,2

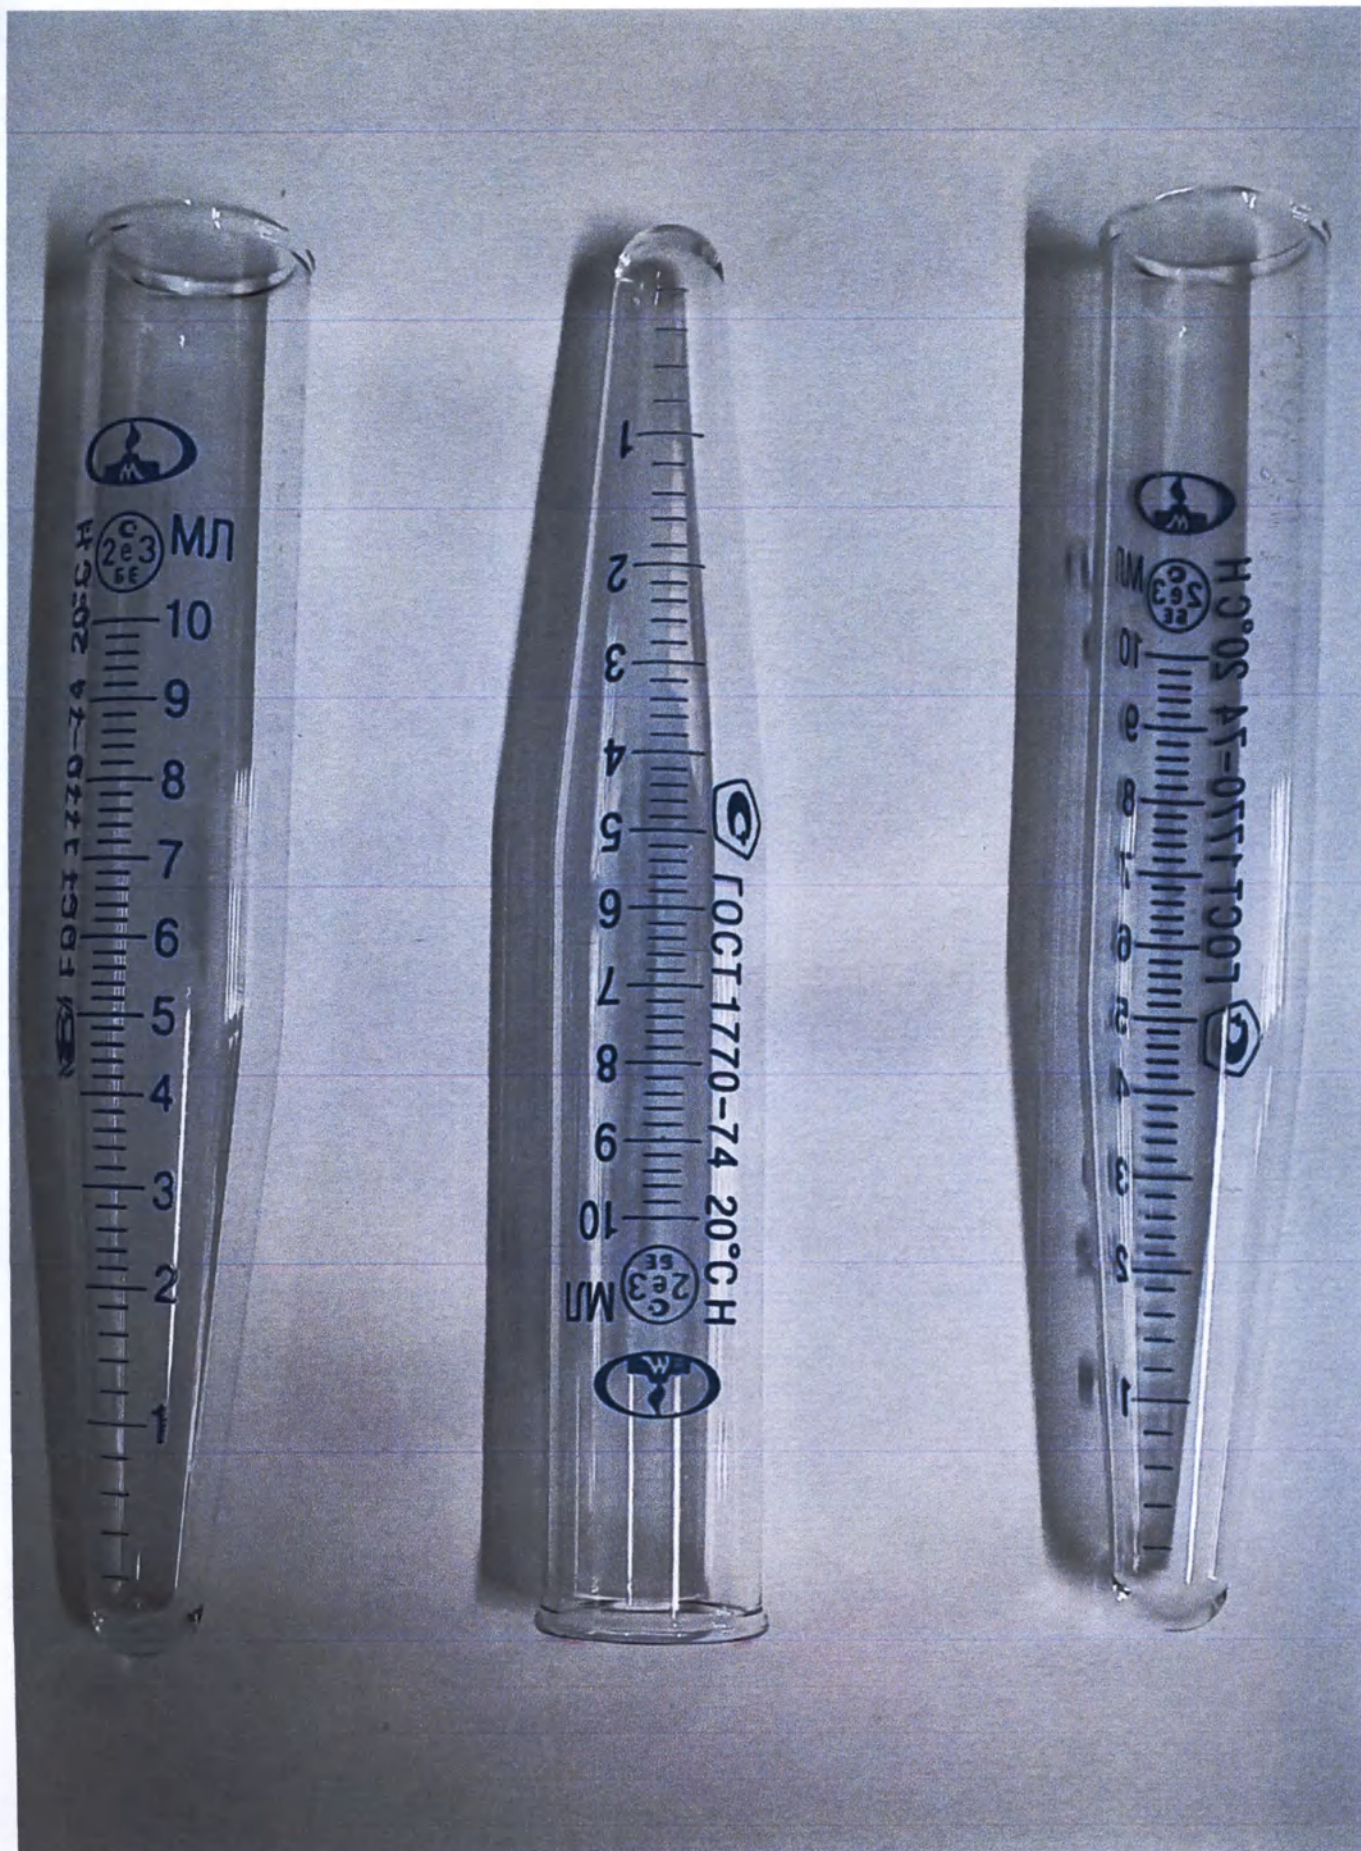


Видаля: ПББ2-10х80, ПББ2-10х90, ПББ2-10х105

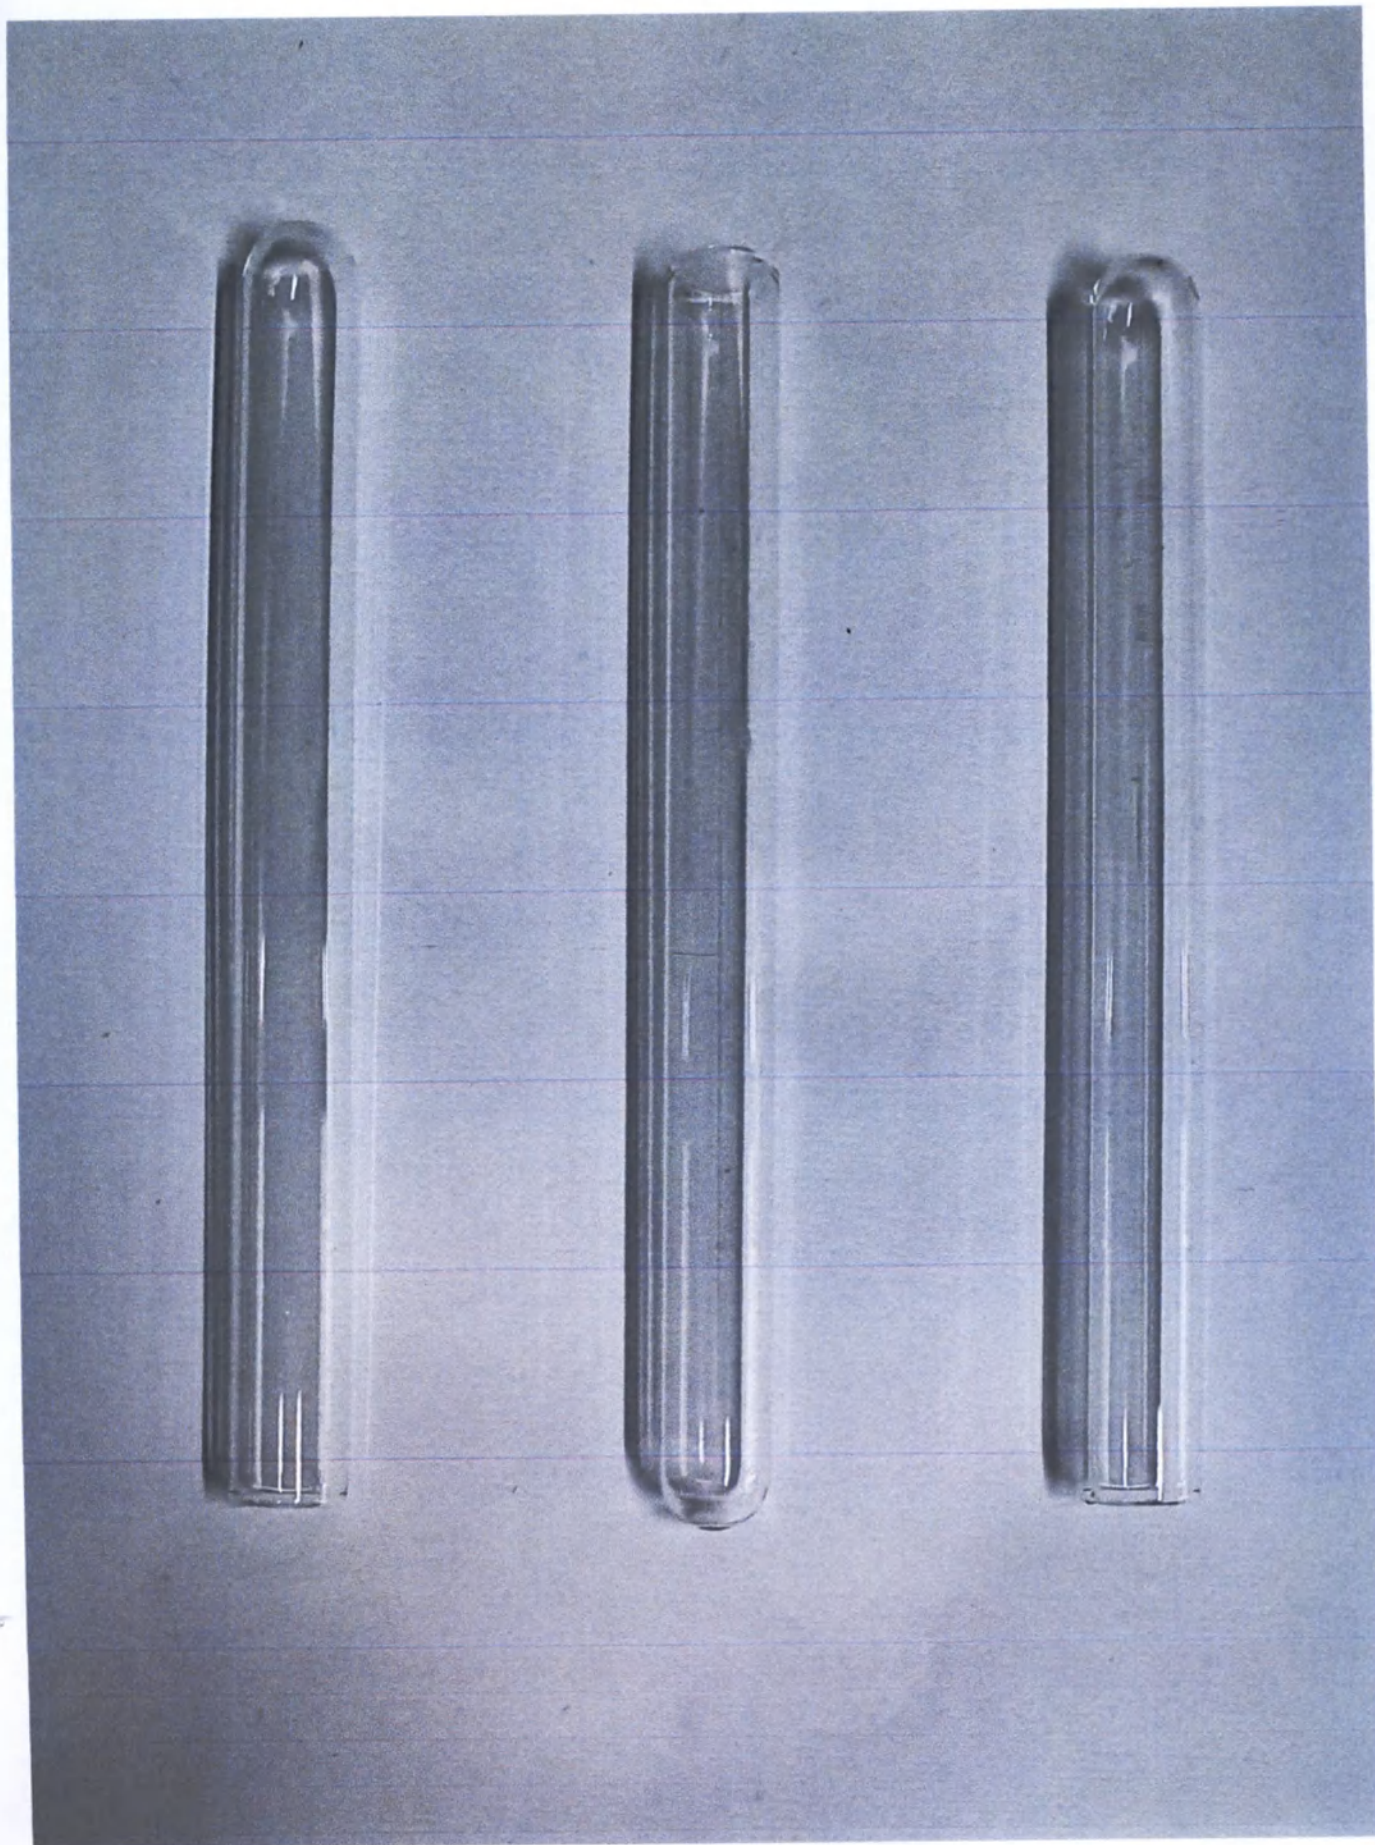


Серологическая: ПС2-10х120, ПС2-12х75, ПС2-12х100, ПС2-12х120

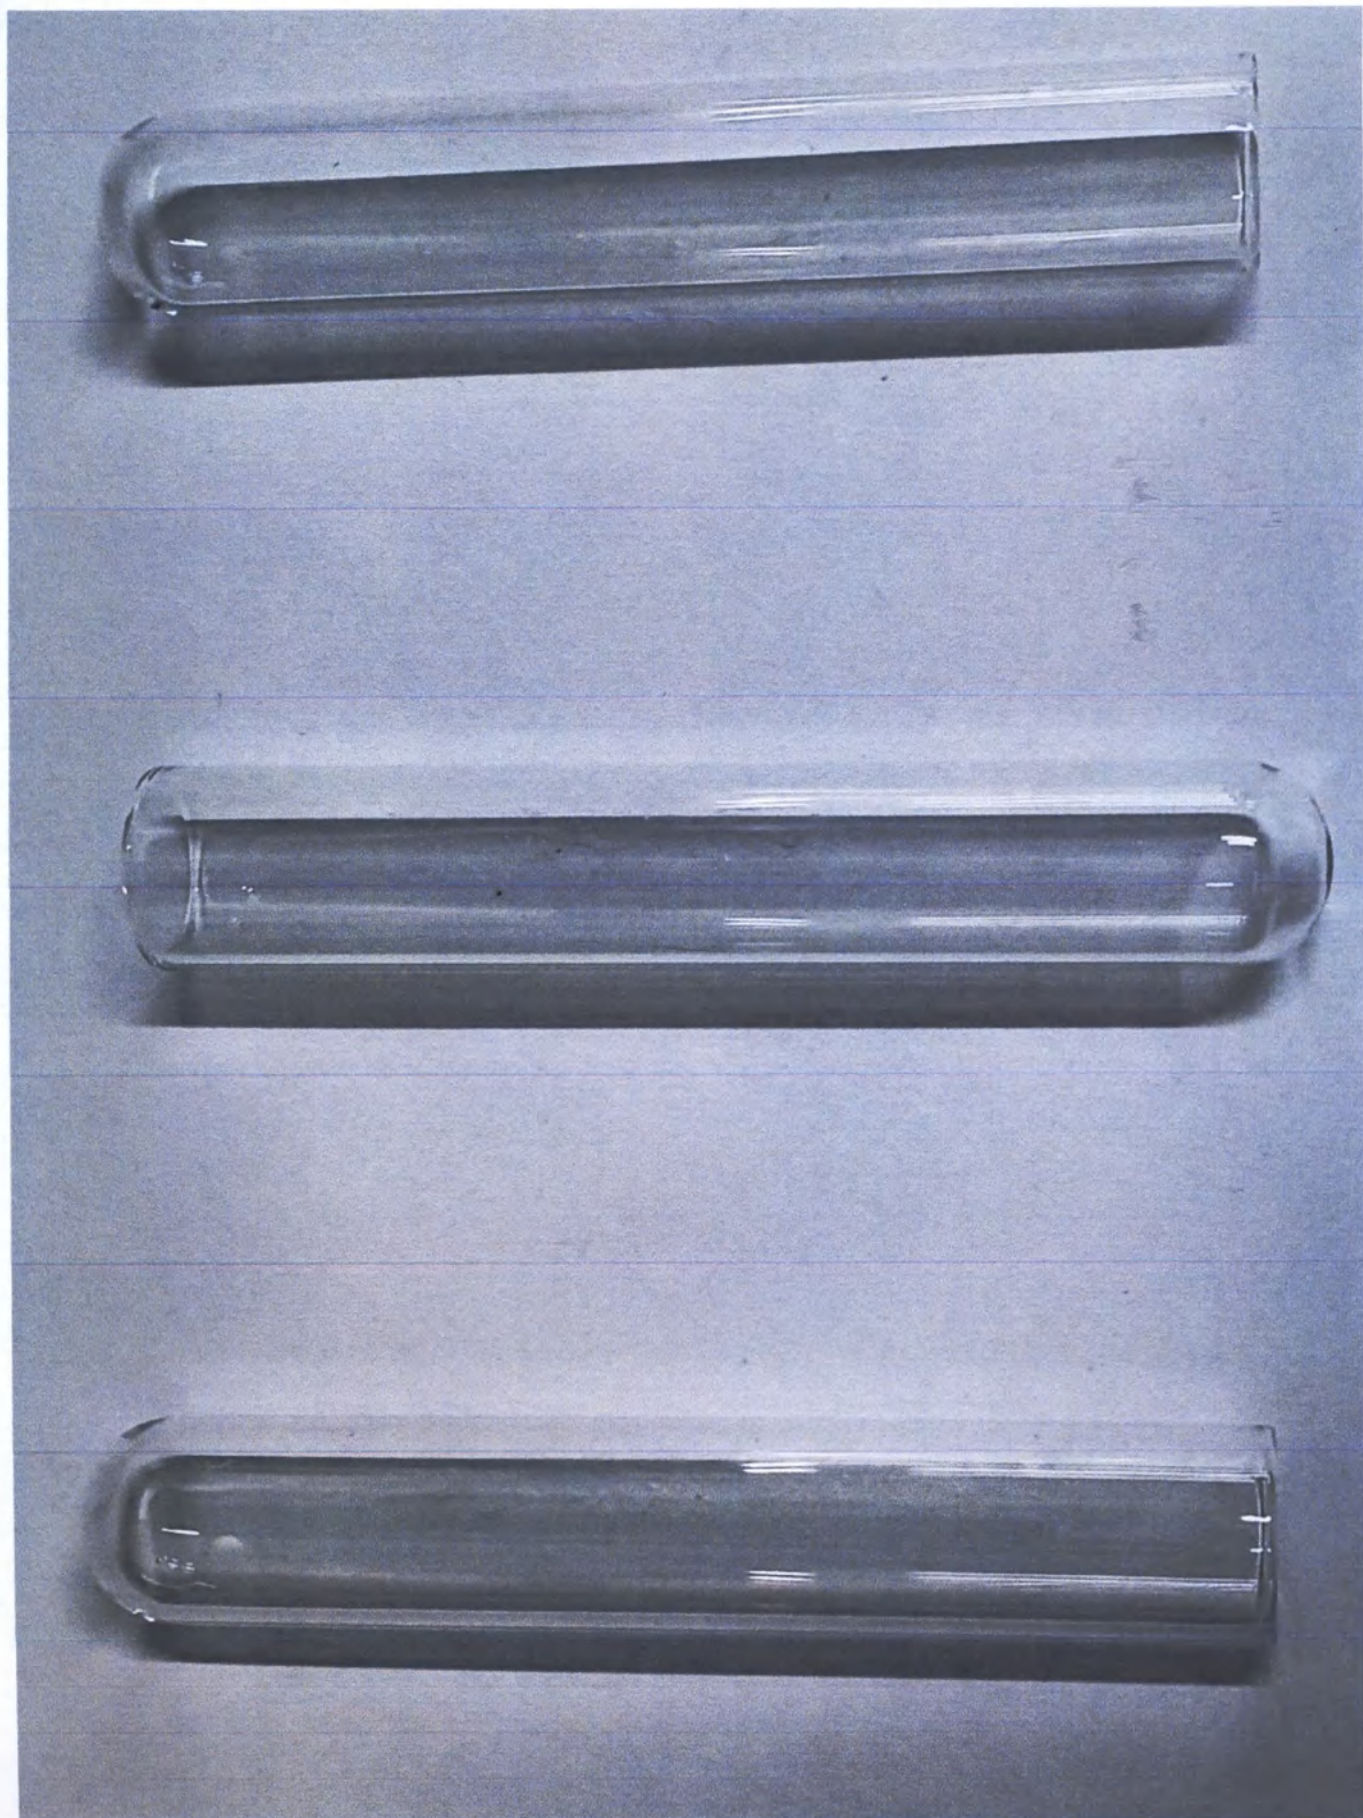

Флоринского: ПФХ1-12х60, ПФХ1-14х60

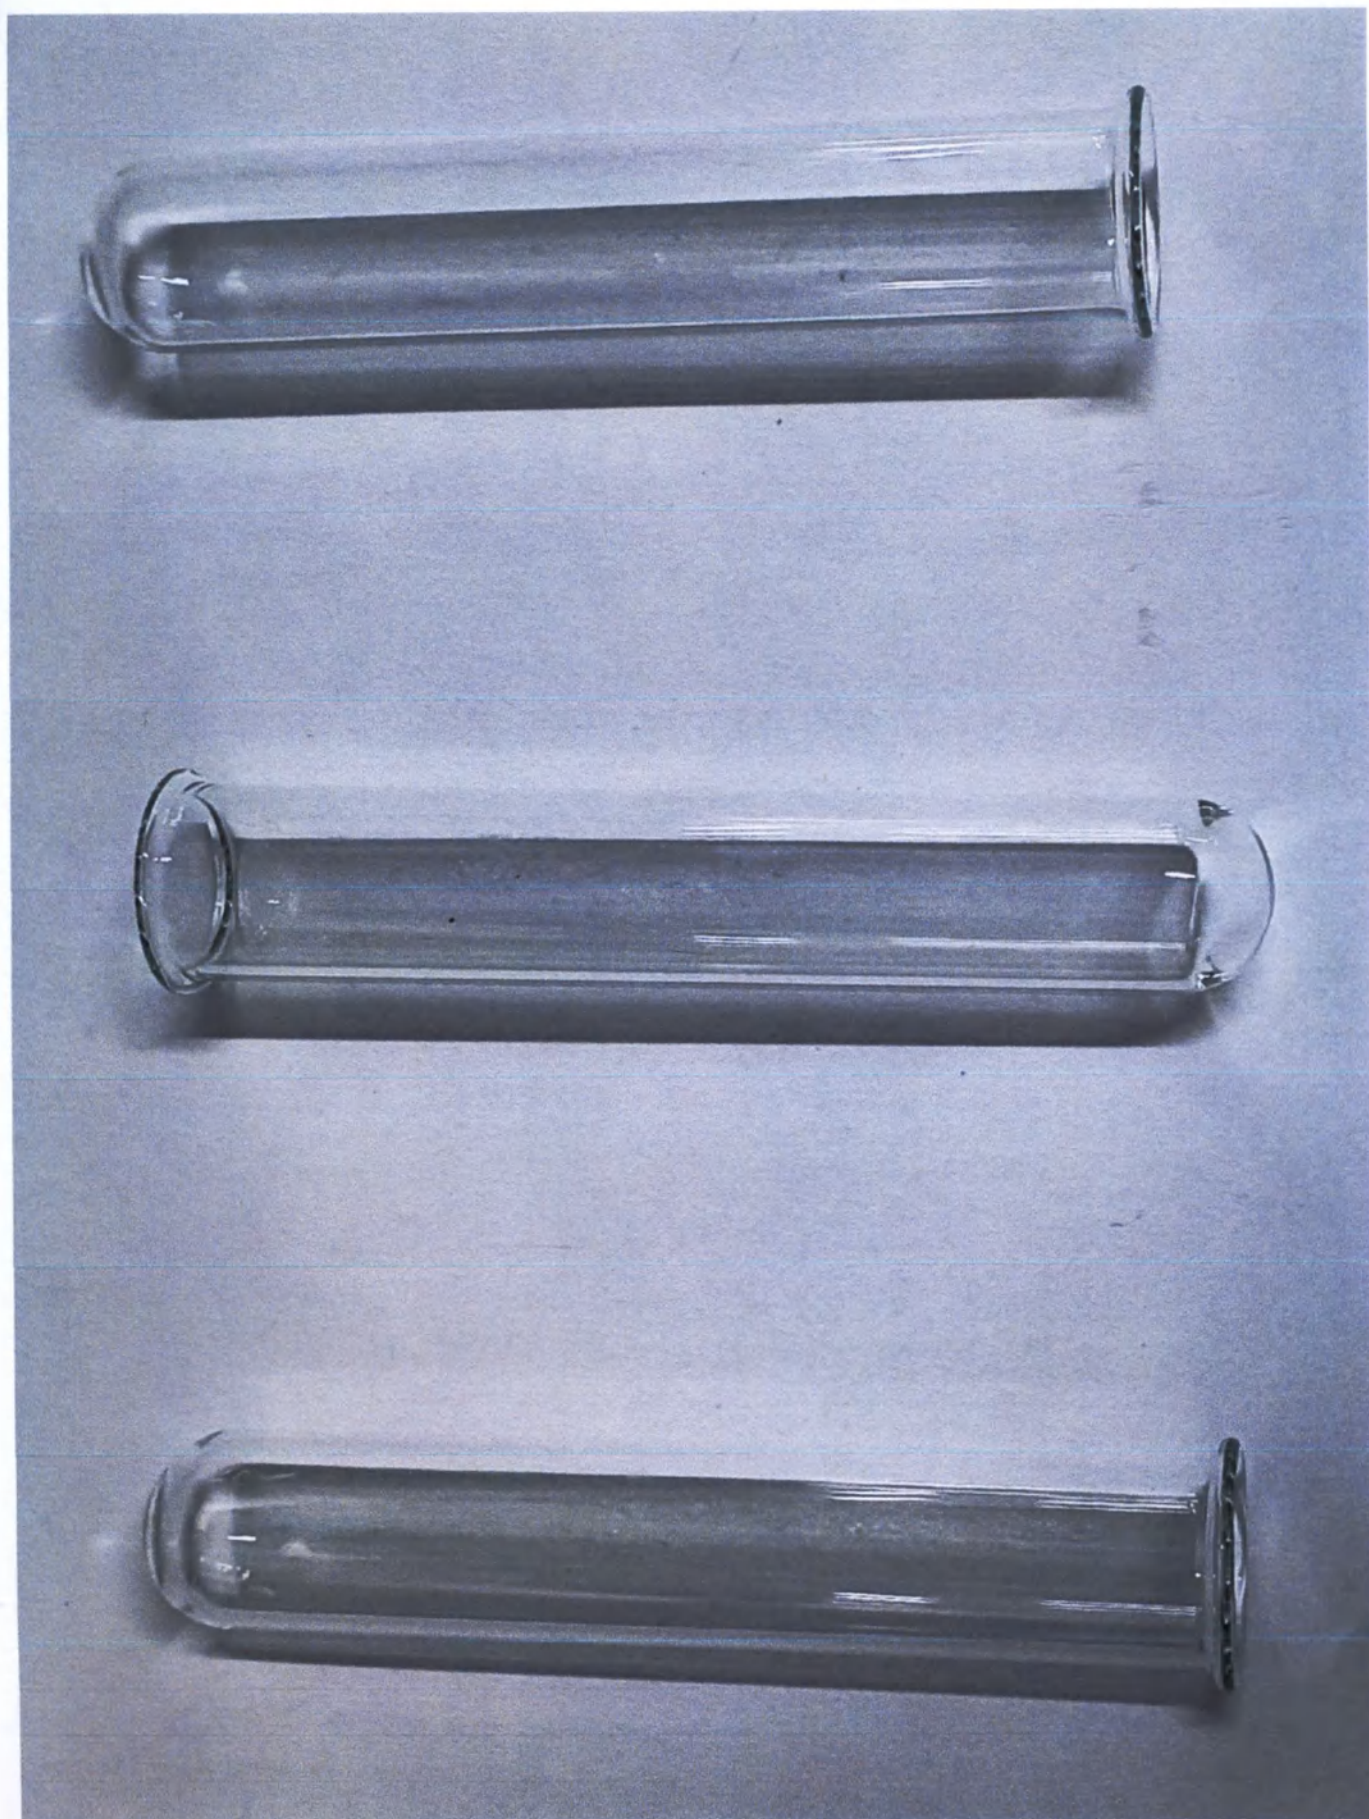


Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-5-14/23

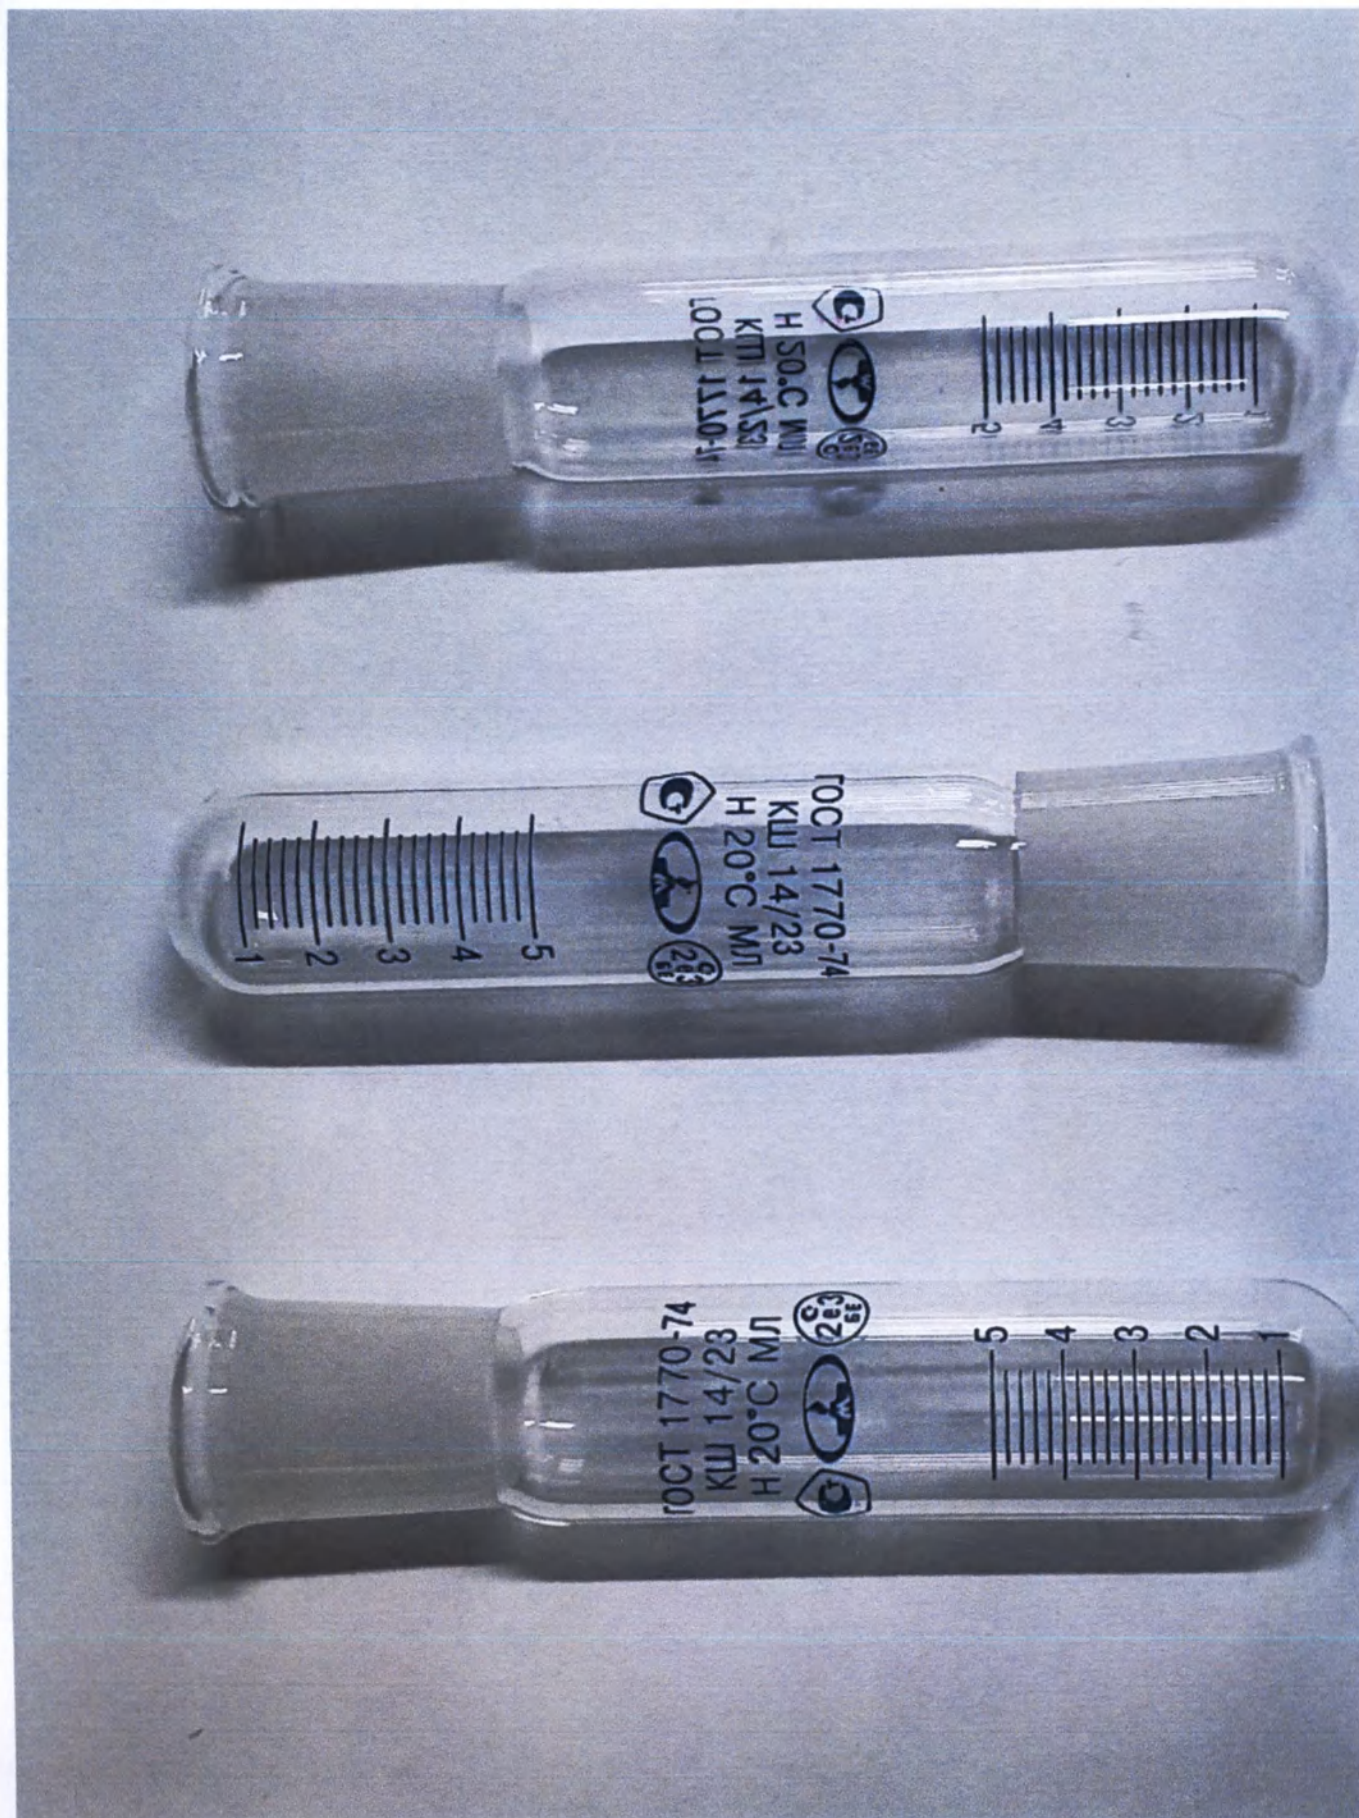


Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-5-10/19




Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-10-14/23

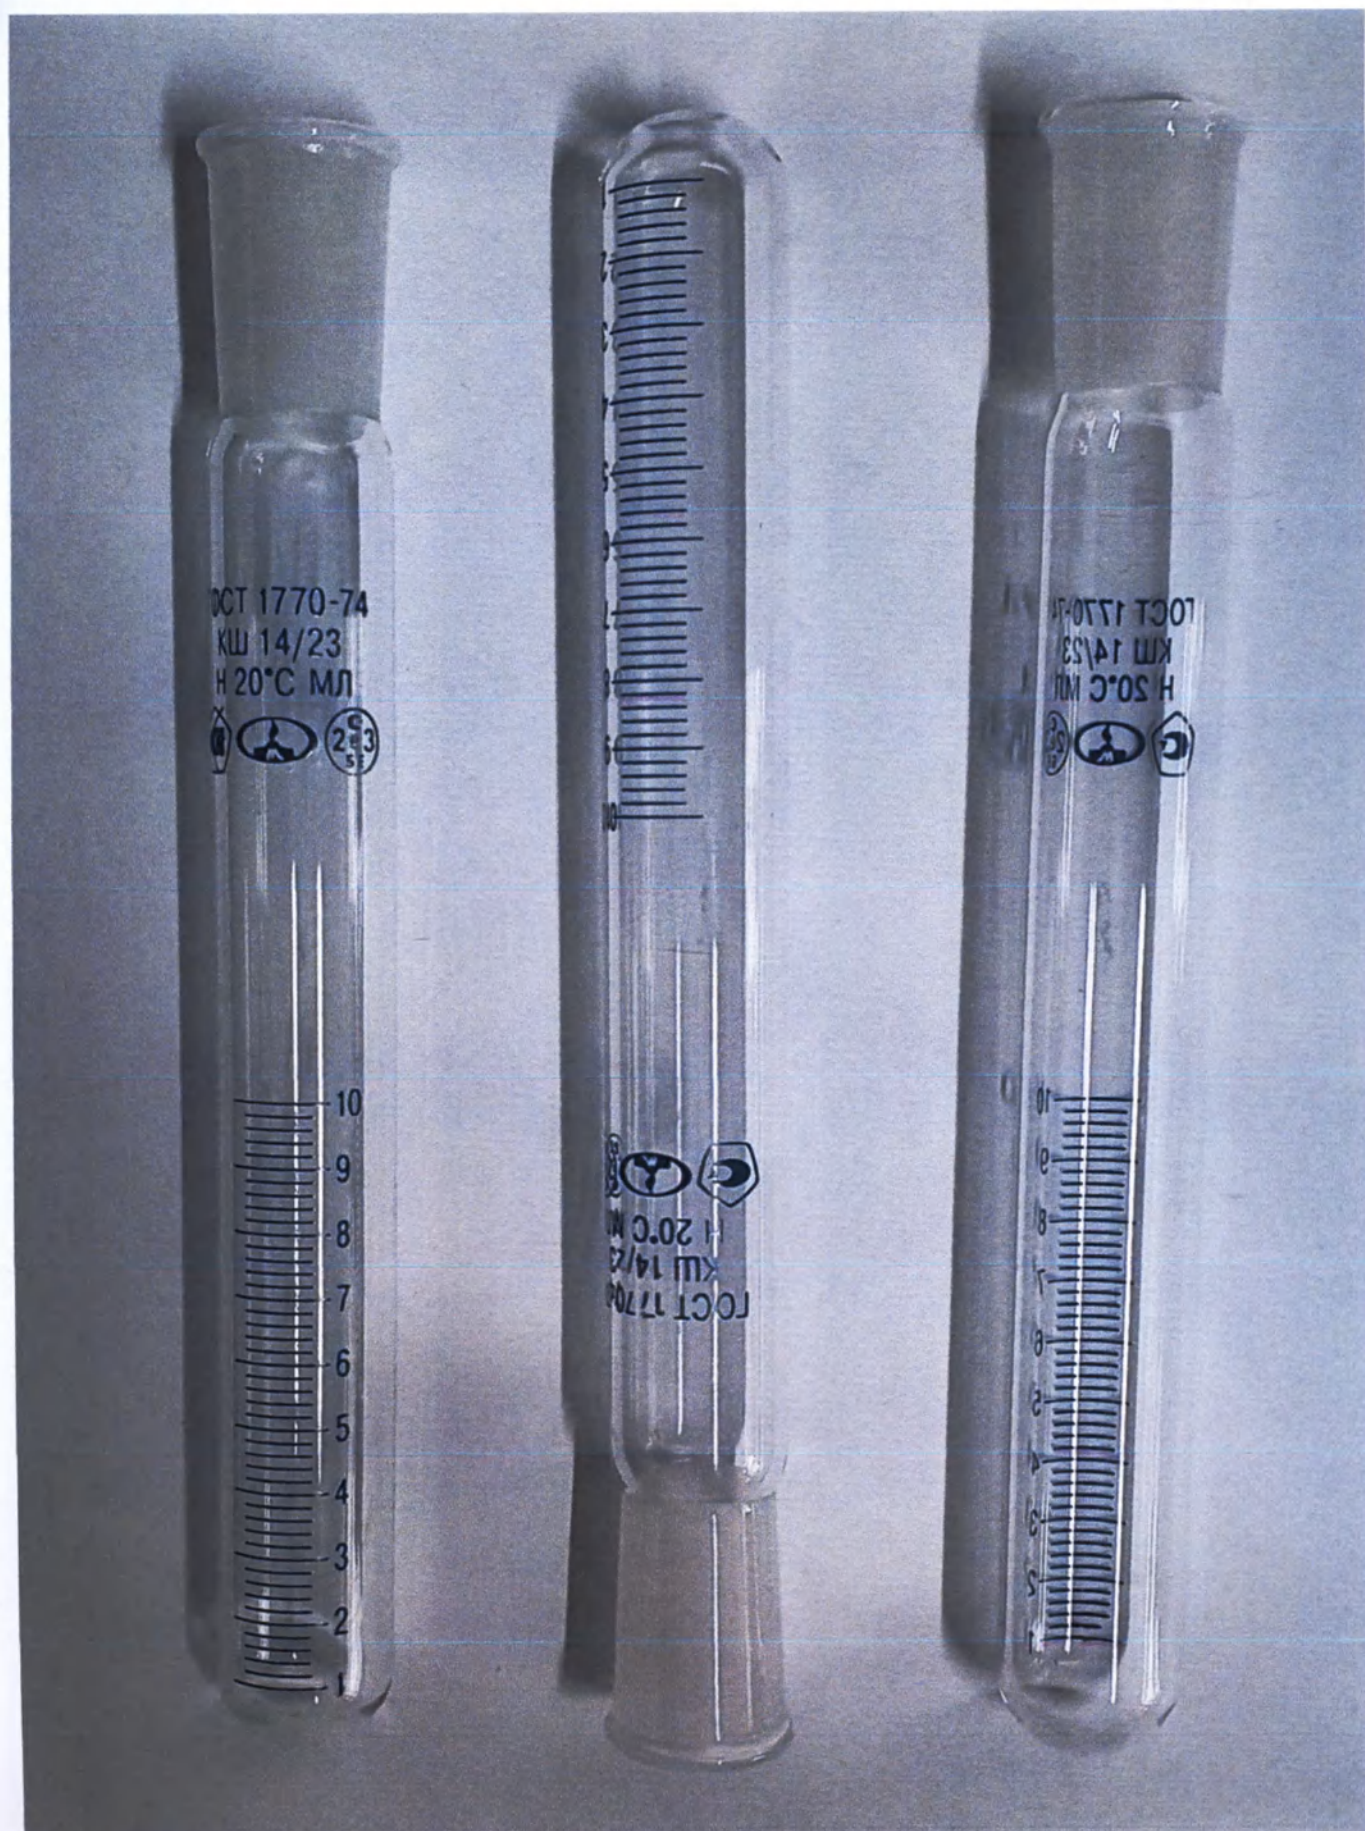


Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-15-14/23

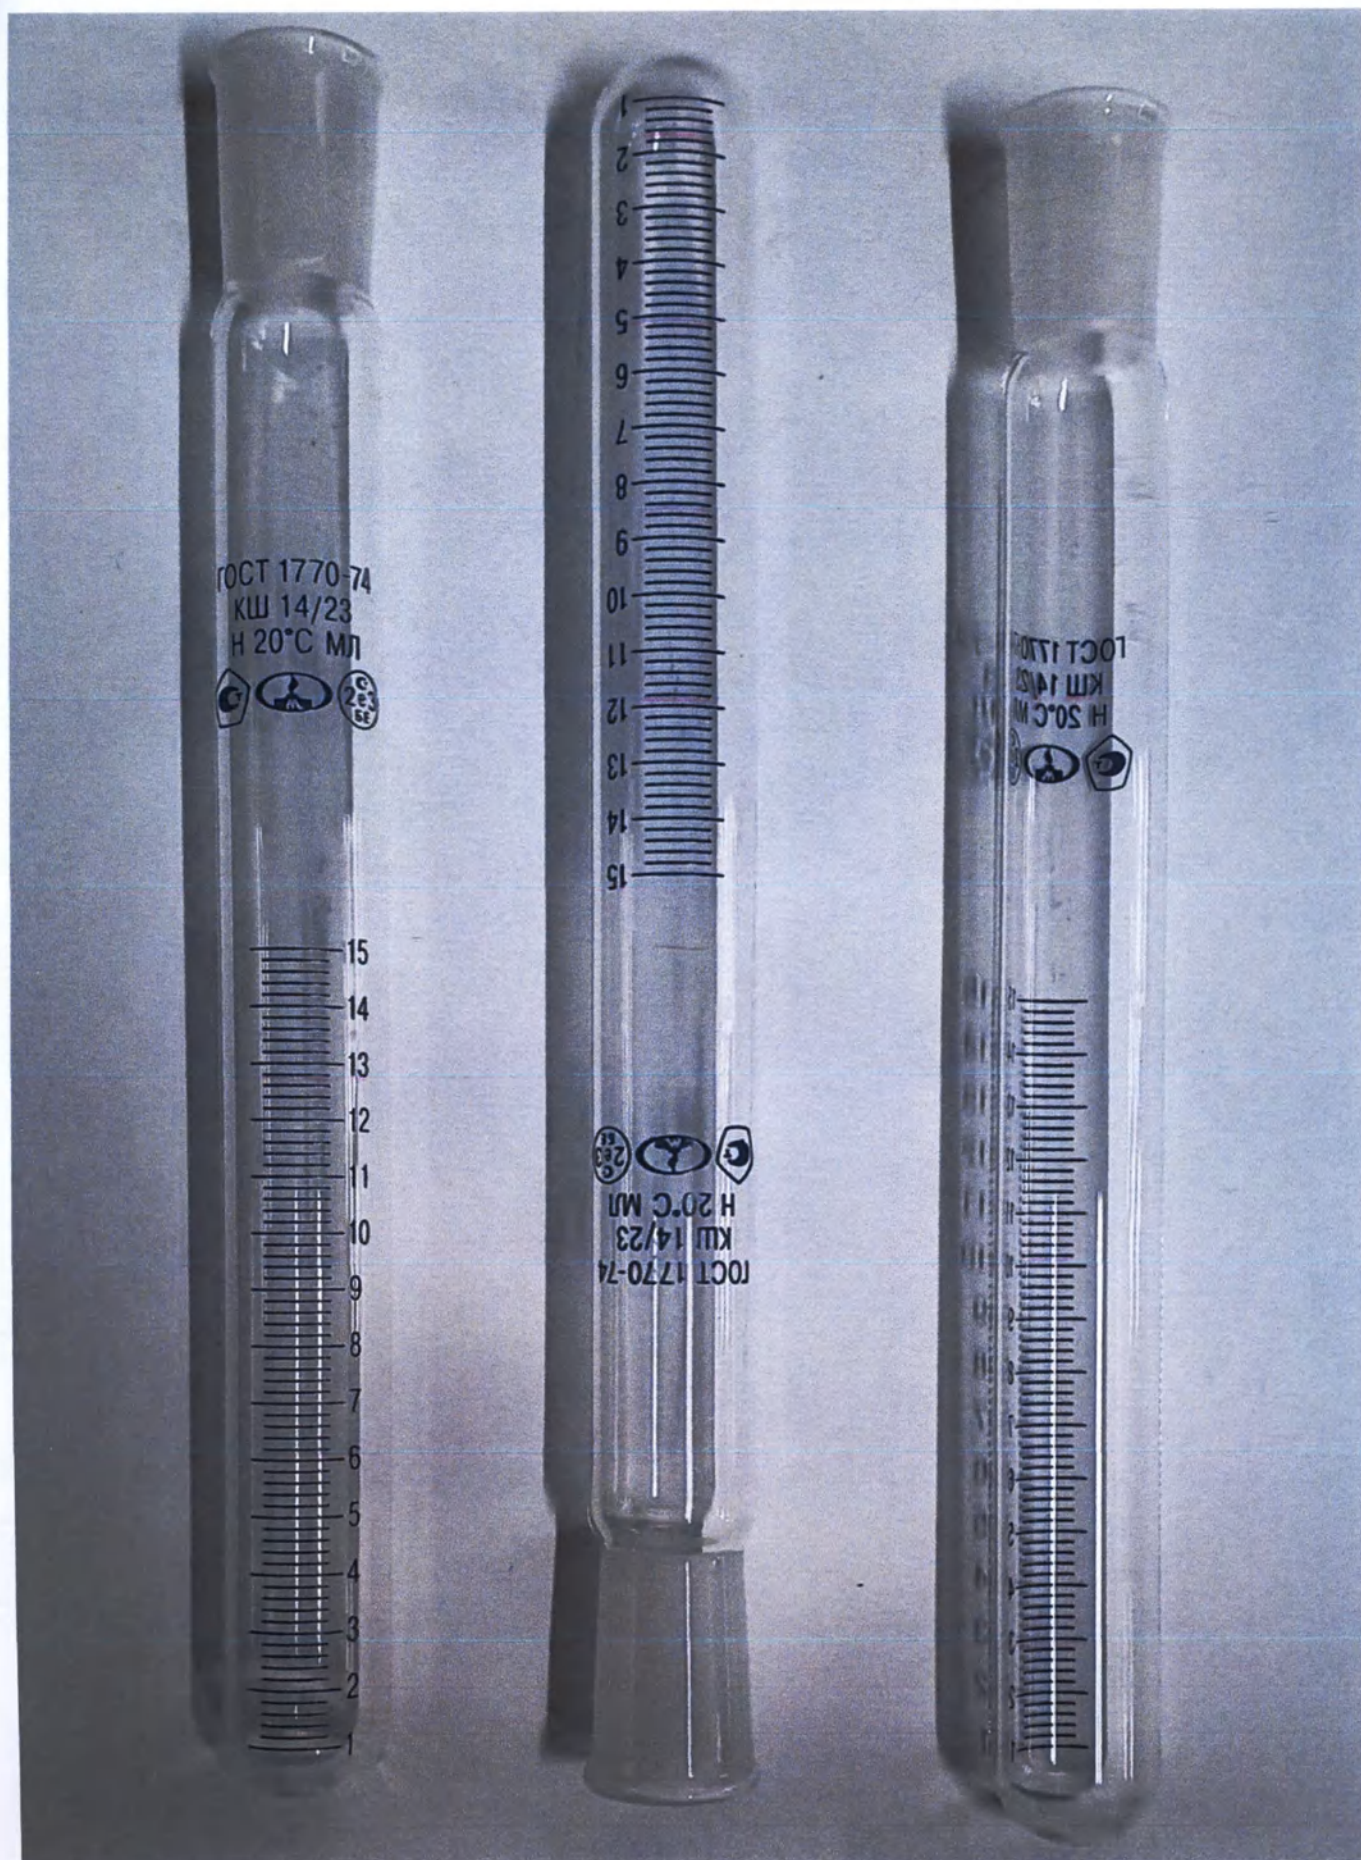

Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-20-14/23

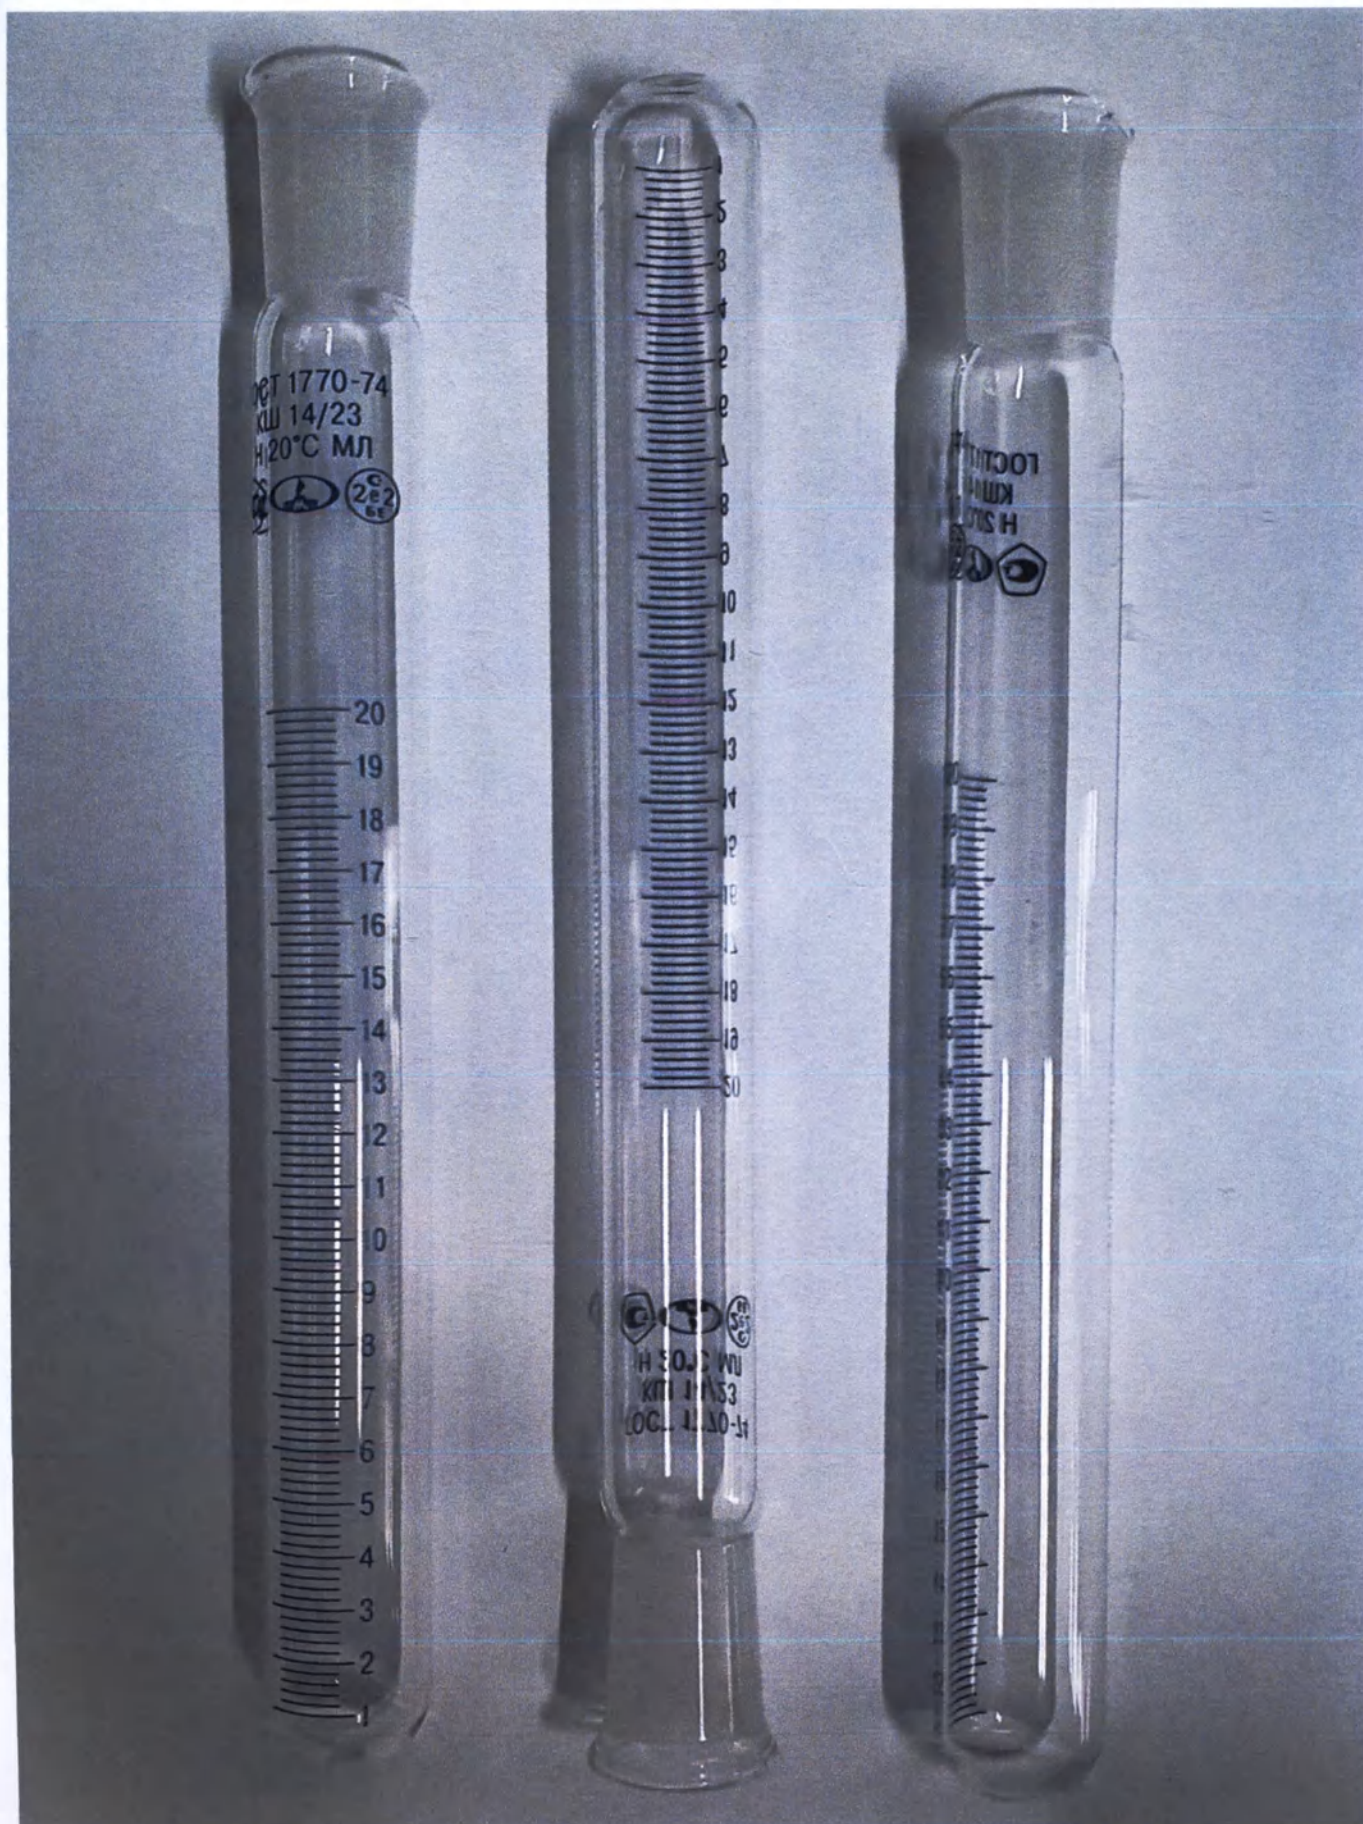


Пробирка мерная со шлифом: ПМ-2-25-14/23

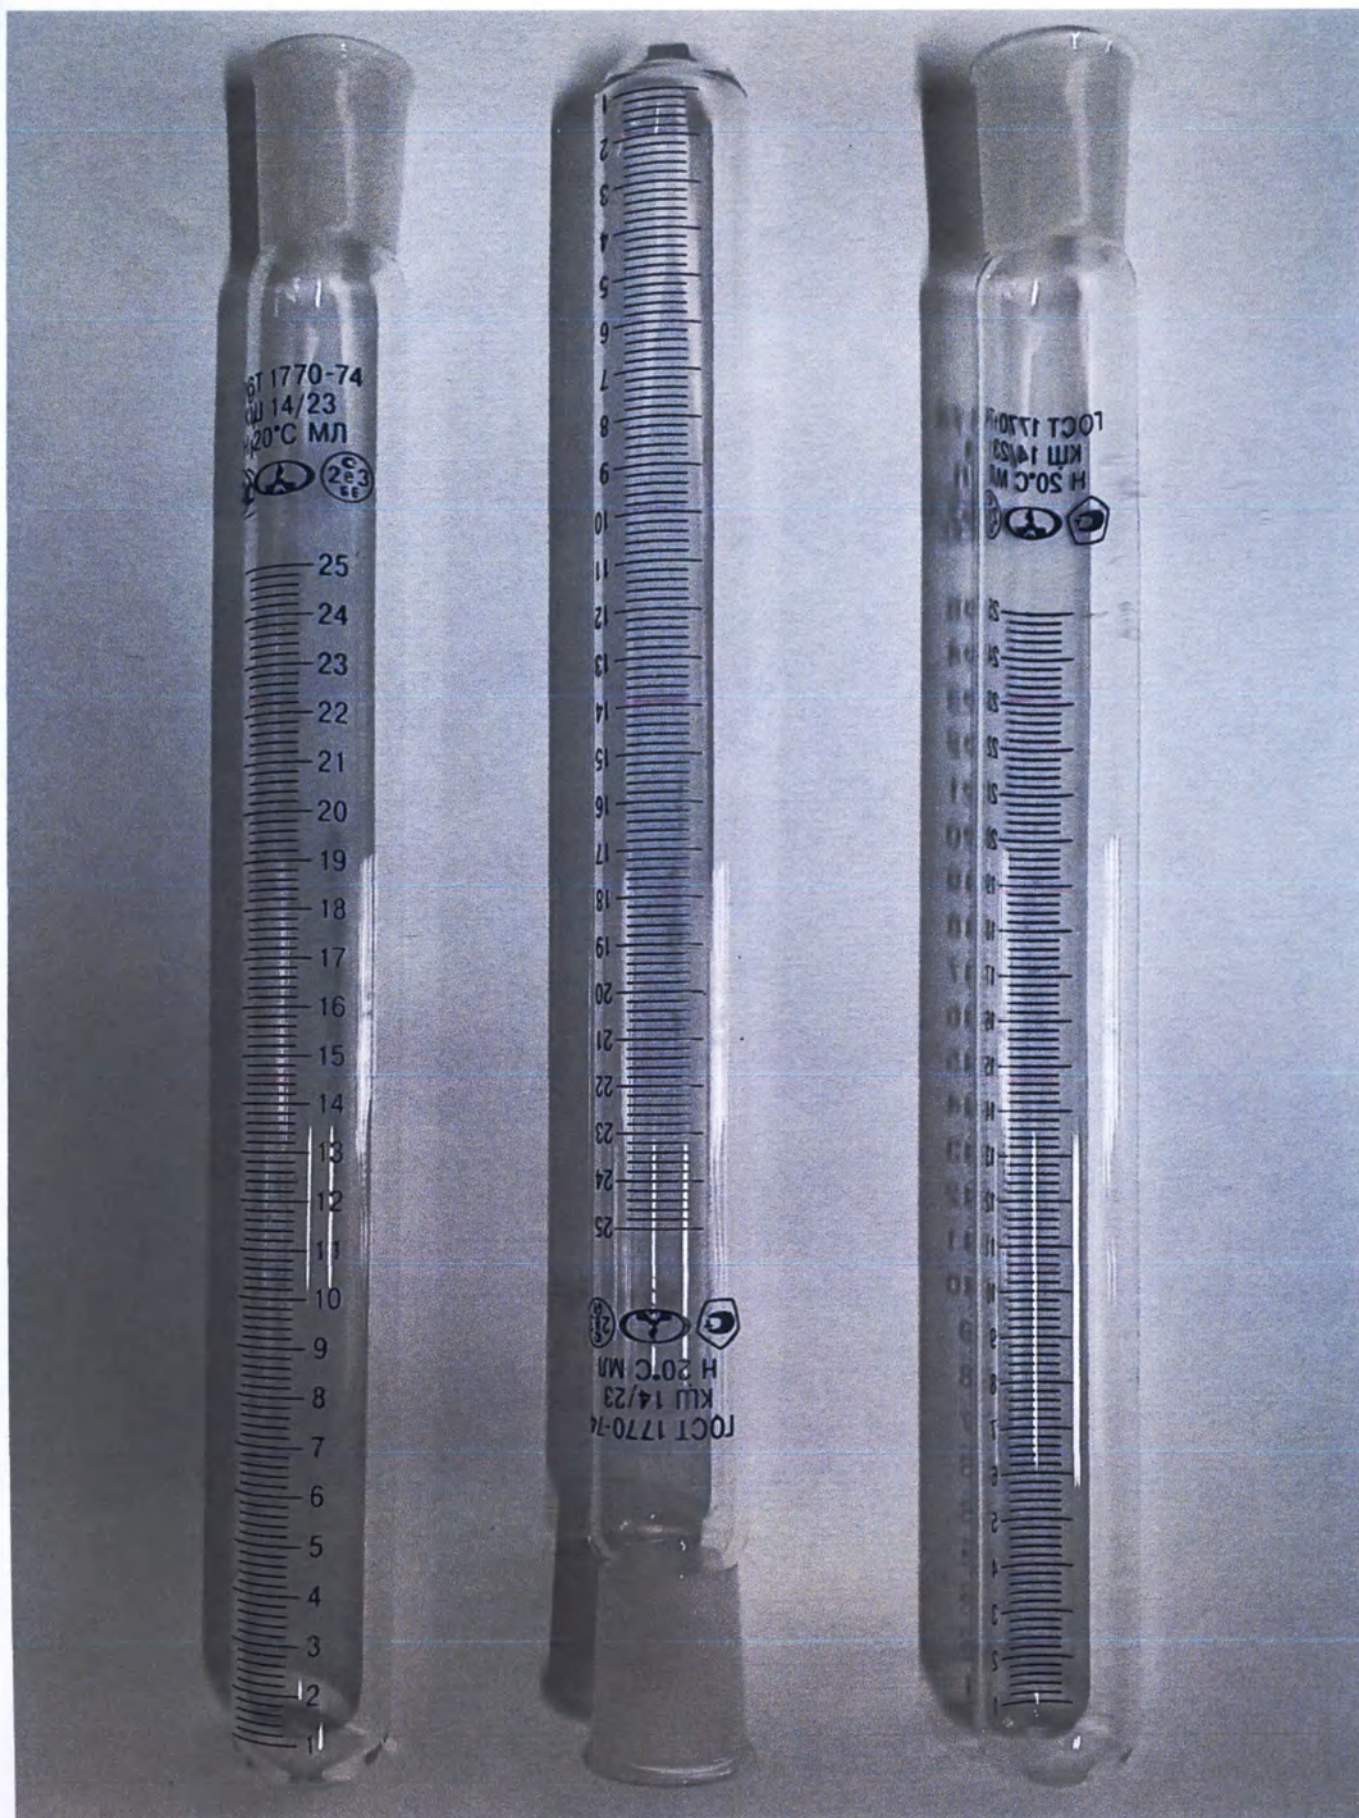


Пробирка с завинчивающейся крышкой: ПЗК-12х75, ПЗК-13х100, ПЗК-16х100, ПЗК-16х150,
ПЗК-20х150



Пробирка агглютинационная: ПА-9х80

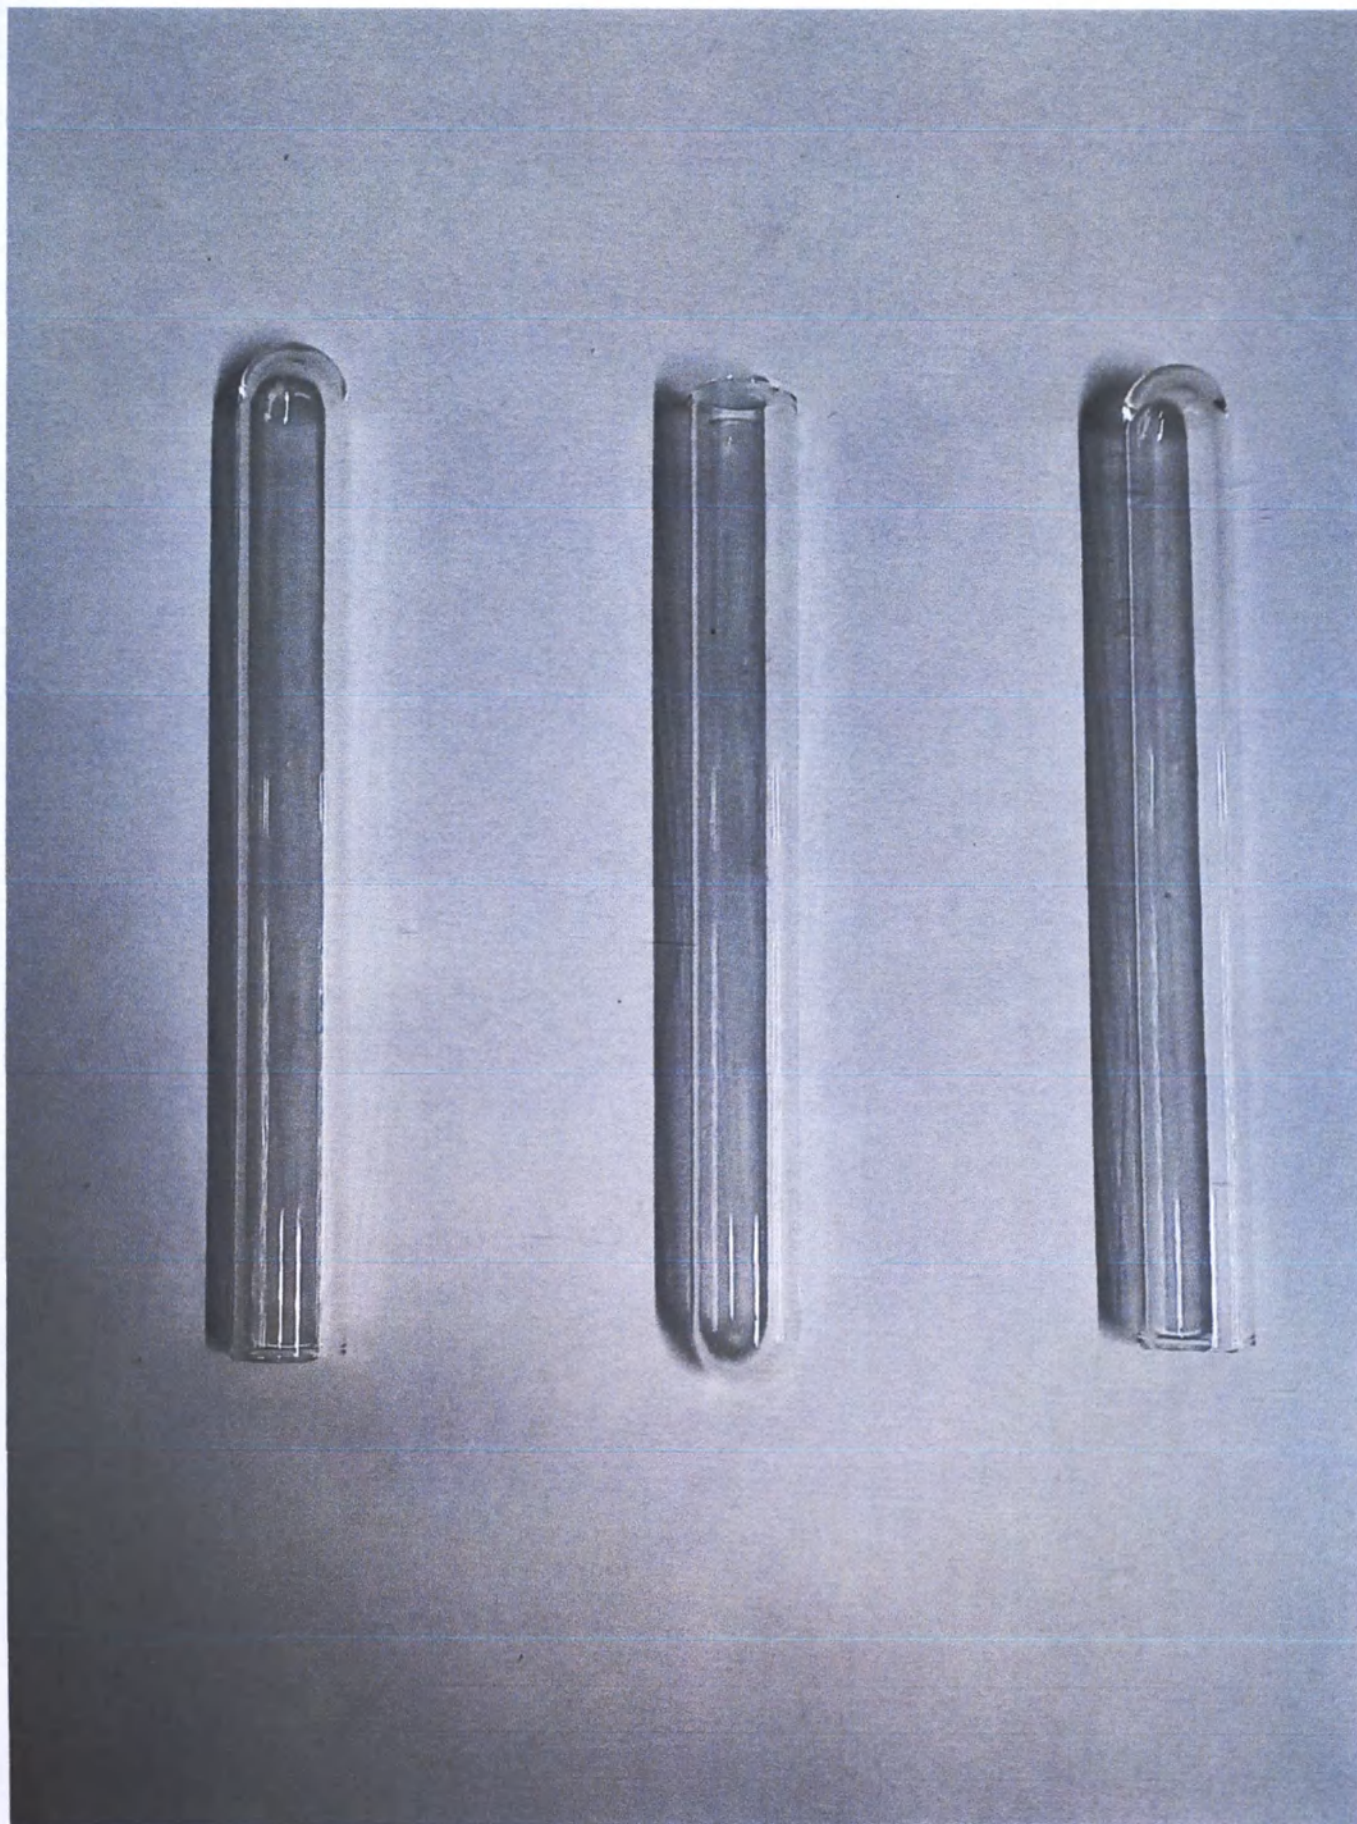

Пробирка колориметрическая: ПК-17х145

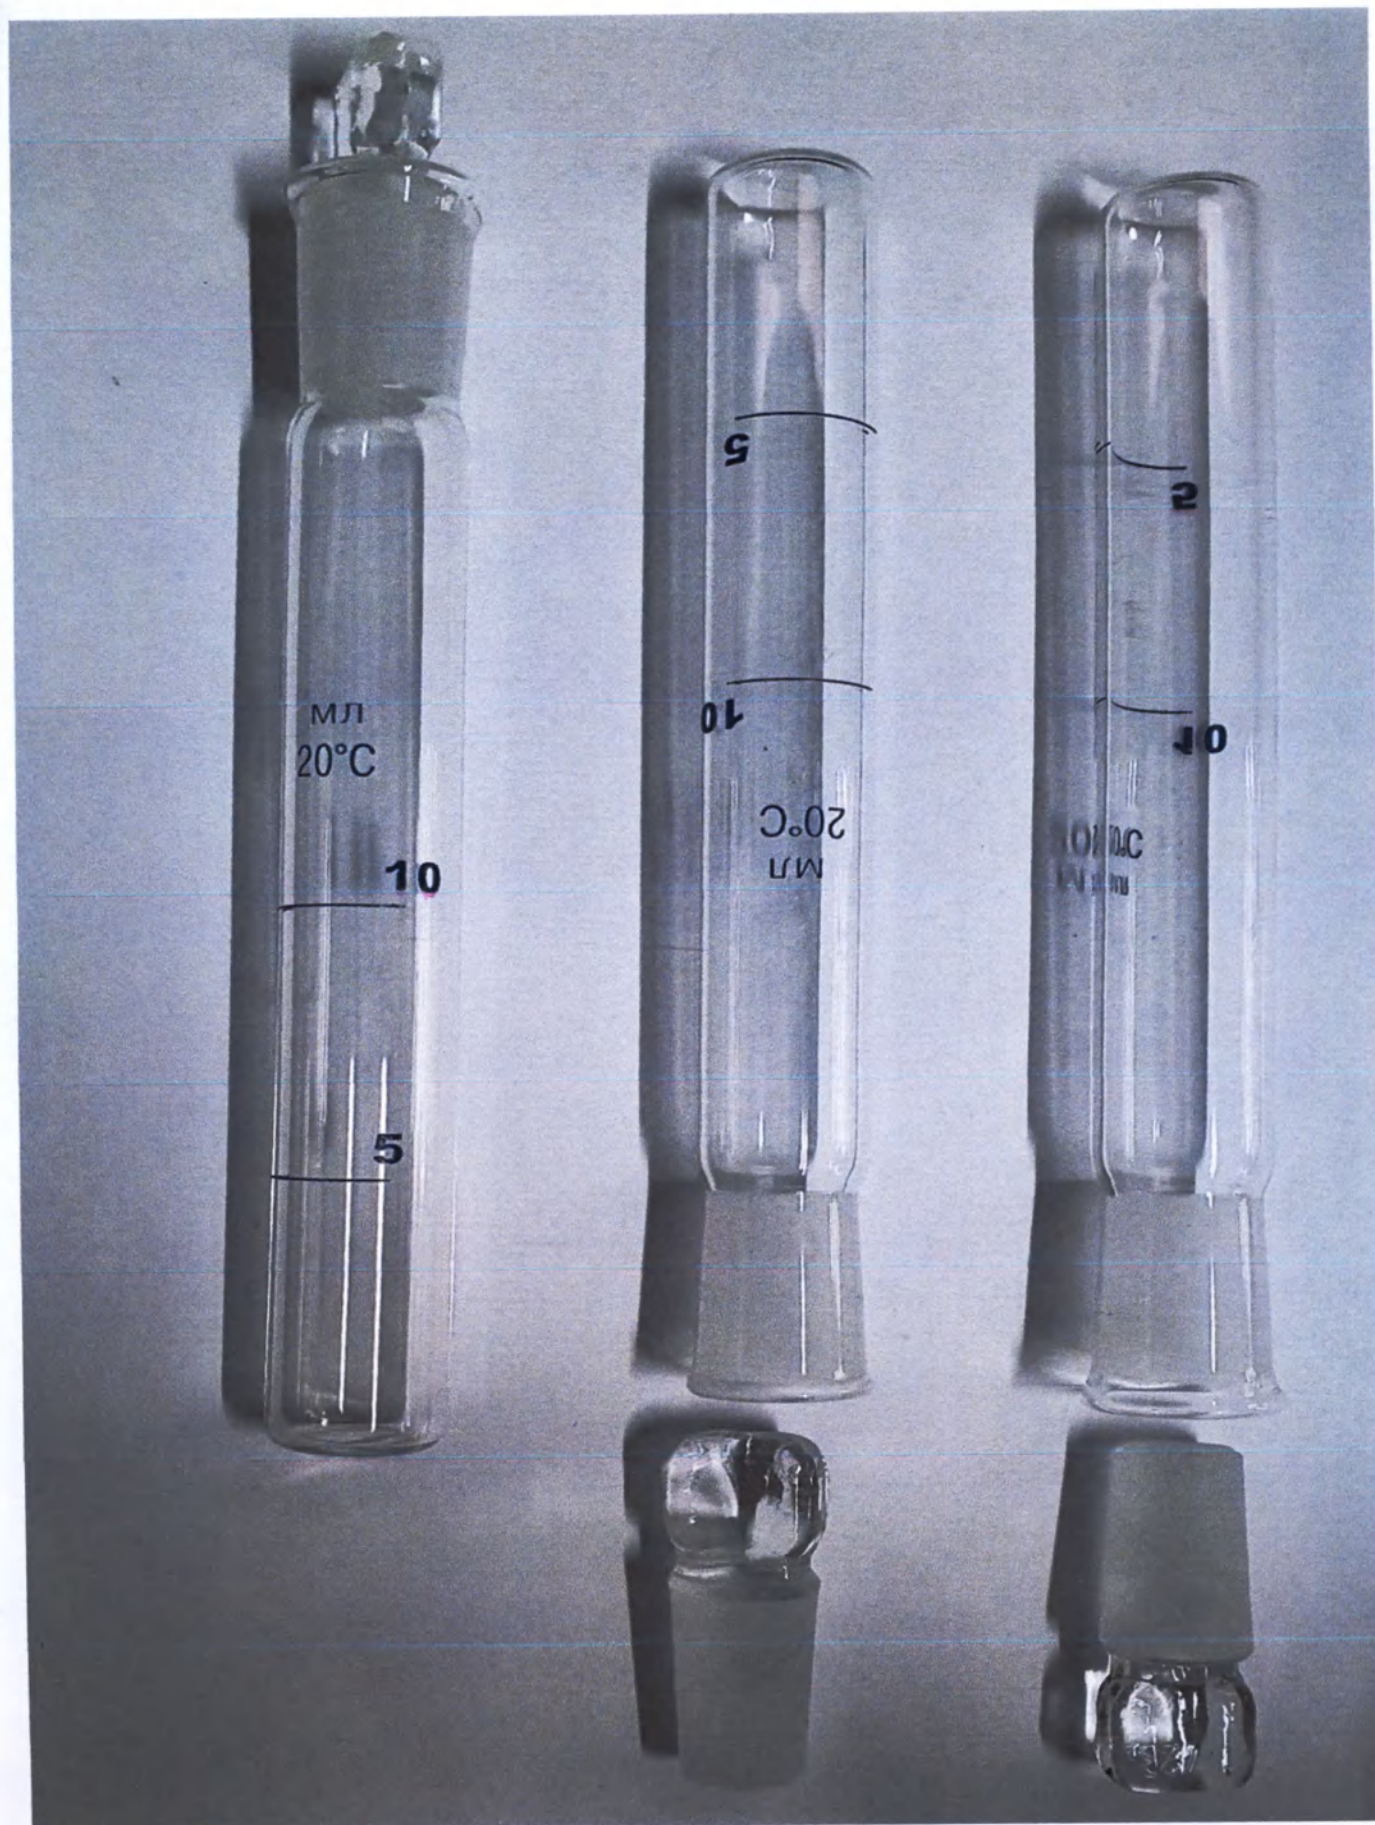

Пробирка колориметрическая: ПК-17х205



Групповая упаковка пробирок мерных со шлифом



Транспортная упаковка



Образцы этикеток медицинского изделия

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

по ТУ 32.50.50-039-29508133-2023.

Этикетки групповой упаковки

поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-5 5 x 30 мм ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ 250 шт. дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 12005502 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Пробирка-поплавок микробиологическая ПМ-10 10 x 30 мм ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ 250 шт. дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 12005501 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Уленгута ПУ-40 (8x40 мм) ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ 250 шт. дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002201 Производитель: ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, 17 а НЕ БРОСАТЬ!
поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Уленгута ПУ-60 (8x60 мм) ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ 125 шт. дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002200 Производитель: ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, 17 а НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Уленгута ПУ-90 (8x90 мм) ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ 125 шт. дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002204 Производитель: ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, 17 а НЕ БРОСАТЬ!	
поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Уленгута (8x120 мм) ПУ-120 400 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002202 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Биологическая (Вассермана) 14x100 мм ПБ2-14x100 500 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002811 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	
поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Биологическая (14x120 мм) ПБ2-14x120 100 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002812 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Биологическая (14x120 мм) ПБ2-14x120 500 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10002813 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	
поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Биологическая (16x150 мм) ПБ2-16x150 100 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10005114 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	поставщик лабораторий МиниМед® 241520, РР, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонье, ул. Шоссейная, д.17а Тел: (4832) 52-47-47, 52-24-52 Факс: 52-24-54 Email: info@minimed.ru www.minimed.ru Пробирки медицинские стеклянные МиниМед Биологическая (16x150 мм) ПБ2-16x150 500 шт/дана ТУ 32.50.50-039-29508133-2023 серия: _____ дата изгот.: _____ упаковщик: _____ арт. 10005117 Производитель: ООО «МиниМед» НЕ БРОСАТЬ!	



**ностальгический
лабораторий**

241528, РР, Бирская обл., Костинск. рн,
с.Сунжава, ул.Шоссейная, 17а

МиниМед®

Тел.: (4332) 41-47-47, 42-34-52 факс: 43-04-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru



Пробирки маркированные стеклянные МиниМед
Биологическая (21х200 мм)

500 Штук в коробе
Биологическая ПБЭН-7-1200

500 Штук в коробе
Биологическая ПБЭН-7-1200

ПБЭ-21х200

200 шт/короб

РУ

ТУ 32.38.30.40-00000000-00000000


Дата изготовления: _____ Серий: _____ Упаковки: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто герметизированной упаковки: _____ кг

ИВД 

арт. **10005207**



Применительно к: ☐ Очистка / ☐ Вытирание ООД «МиниМед»

Внимание, средство имеет запах не резкий, интенсивный запах имеет 90%,

Препарат, срок годности: при 2-20 С до 18-мес,
вскрытый препарат имеет срок 180С.

   **НЕ БРОСАТЬ!**



восстановившие лабораторий
241528, РФ, Брянская обл., Брянский р-н,
с.Сумовское, ул.Заводская, 11а

МиниМед®
Тел.: (4832) 8247-67, 8246-62 факс: 8246-64
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Химическая (14x120 мм)

62 Шлифованный
стекло (ГОСТ 681-78)

83 Пробирки вольфрамовые
кварцевые (ПХТ-14x120)

ПХ1-14x120

100 шт/дранка

РУ
ТУ 32.88.50-039-29508133-2023

арт. **10002815**

Производитель: / Беларусь / Вьетнам: ООО «МиниМед»

Химическая, оптический коэффициент пропускания 99%,
темперостойкость, при t° от -80 до +100°C,
выдерживает автоклавную обработку

НЕ БРОСАТЬ!



2 400 094 917 393 801





поставщик лабораторий

341520 РР, Калинин обл., Калинин р-н,
с.Сучовское, ул.Земляная, 17а

МиниМед®

Тел.: (4832) 92-67-47, 93-36-52 факс: 93-36-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Химическая (14x120 мм)

ПХ1-14x120

500 шт./дана

Кл: Шлипы тиглер

химическая ПХ1-14x120

Вид: пробирки химические

химическая ПХ1-14x120

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Упак.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Прокладка: резина / Силикон / Выстирка: **ООО «МиниМед»**

Крышечки, ставятся при t от -60 до +100°C, выдерживают нагрузку 500Н. Температурный диапазон: от -60 до +100°C. Химическая нагрузка 100%.

РУ

ТУ 32.50.50-030-20060133-2023

арт. **10002814**



2 4000949739397

НЕ БРОСАТЬ!



**постовский
лабораторий**

241528, РМ, Крымский аэро., Крымский р-н,
с.Сумское, ул.Дзюловская, 17а



Тел.: (812)32 62-61, 62-64-62 факс: 62-64-64
Email: info@muni-med.ru www.muni-med.ru

Пробирки медицинские стандартные Мунимед

Химическая (16х150 мм)

ХА: 0,05 мл/шт
 емкость: 10х10х100
 ВТ: пробирки медицинские
 стандартные 16х150мм

ПХ1-16х150

100 ШТ/ДАНА

ТУ 92.92.00-030-28808135-0023

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Идентификация: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто индивидуальной упаковки: _____ г

Продукция сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 28808-13

Примечание: продукт не имеет маркировки, соответствующей классу МС, так как относится к классу МСВ, так как относится к классу МСВ, так как относится к классу МСВ.

ар. 10005115



ИЗДАНИЕ 01.01.2014

НЕ БРОСАТЬ!

200004733211



**ПОСТОВЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ**



241518, Мн, Кричевская обл., Кричевский р-н,
С.Суровики, ул.Школьная, 71а

Тел: (0812) 10-07-01, 02-04-52 факс: 02-04-54
E-mail: info@minskmed.by www.minskmed.by



Пробирки лабораторные стандартные МинскМед
Химическая (16х150 мм)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
РЕАКТИВОВ

ИЗГОТОВЛЕНО В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПХ1-16х150

500 шт./упаковка

ПУ 12.14.10-029-0100033-0003

Дата отчета: _____ Серия: _____ Упаковки: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто не гарантируется производителем



Производитель: «ФармДизайн» (Полное ООО «ФармДизайн»)

Адрес: г. Минск, пр. Мухоморова, 100/1

Телефон: +375 (0) 29 68 00 00

Сайт: www.farmdesign.by

арт. 10005116



НЕ БРОСАТЬ!



**ПОСТОВЫЕ
лаборатории**

101010, Р.п. Березина ул. Красной реч.
д.Судорож, ул.Школьная, 17а

МиниМед

Тел.: (02932) 93-47-47, 93-34-53 факс: 93-34-51
E-mail: info@minimed.by www.minimed.by



**Пробирки медицинские стандартные МиниМед
Химическая (21х200 мм)**

К1 Устойчивость к
химическим веществам
согласно ГОСТ 17-139

К2 Прочность каталитическая
согласно ГОСТ 17-139

ПХ1-21×200

200 шт./дупл.

ТУ 10005208-00000001-0000

Дат. вып.: _____ Серия: _____ Упаковка: _____

Масса нетто _____ и Масса брутто _____

Масса нетто перепечатывается упаковкой  

Промышленность (Фабрика) (Выпускает) ООО «МиниМед»

Заводской номер (сер.) и Штрих код

Информация о продукте и упаковке

Информация о производителе

Информация о дате выпуска

 **НЕ БРОСАТЬ!**



**ПОСТОВЫЕ
лаборатории**



241520, РМ, Брестская обл., Брестский р-н,
с.Сутынка, ул.Школьная, 17а

Тел.: (4832) 52-07-07, 52-04-52 факс: 52-04-54
E-mail: info@minmed.ru www.minmed.ru

Проверки медицинских устройств МинМед
Биохимическая (16х120 мм)

*ИЗДАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИНМЕД» 2006*

*ИЗДАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИНМЕД» 2006*

ПБХ-2 16х120

100 ШТУКА

ТУ 71.50.30.00-0090013-0053

Дата изготовления: _____ Серийный номер: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто в герметизованном упаковке: _____ г

Продукция произведена / выпущена / выдана ООО «МинМед»

Исходит из 100 шт. в упаковке, в которой находится 100 шт.

Примечание: при 100-м и 500-м шт. в упаковке

арт.10005107






НЕ БРОСАТЬ!





поставщик лабораторий

241228, РБ, Березинский обл., Березинский р-н,
с.Сухоминка, ул.Ю.Сосновская, 17а

МиниМед®

Тел.: (4832) 93-67-97, 92-24-52 Факс: 92-04-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Биохимическая (16x120 мм)

☒ Шкала титрования
Биохимическая ПБХ-16x120

☒ Пробирка опалесцентная
Биохимическая ПБХ-3-16x120

ПБХ-2-16x120

500 ШТ/ДАНА

РУ _____

ТУ 12.50.50-039-29508133-2823

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Упак.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг **ND** 

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель / Импортёр / Выпущено: **ООО «МиниМед»**

Хранить складир при t от -30 до +30°C, влажность воздуха менее 90%. Транспортировать при t от -30 до +30°C, влажность воздуха менее 90%.



НЕ БРОСАТЬ!



2400094973943



**постоянный
лабораторий**

201520, Рр. Брестский обл., Брестский р-н,
д.Слуцкое, ул.Школьная, 17а

МиниМед

Тел. (4832) 82-67-07; 82-64-52 факс: 82-64-56
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru



Пробирки медикленические стеклянные МиниМед
Центрифугиная неградуированная
ПЦПГ (17х105)
ВР (для центрифугирования)
Материал: стекло
Центрифугирование: 17х105 ХС
Центрифугирование: неградуированная

П-1-10 ХС

100 шт./ДАН

РУ

ТУ 32.81.51.639-01988(13).0023

Длина шейки: _____ Сервис: _____ Упаковка: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г  

Масса нетто герметизированной упаковки: _____ г

Примечание: / В-наблюд / Выходит: ООО **дистрибутор**

Внимание: хранить при t от 0 до +20С;
использовать только после СМР;
использовать только при t от 0 до +20С; +20С;
использовать только после СМР.




НЕ БРОСАТЬ!


арт. **10005006**







поставщик лабораторий

241528, РР, Брейтовск обл., Брейтовск-мн,
с.Сумовское, ул.Мисловская, 17а

МиниМед®

Тел.: (4932) 32-67-47, 32-34-52 факс: 32-24-04
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стандартные МиниМед

Центрифужная неградуированная

ПЦНГ (17х105)

Б.Б. Шумилов г/губернатор ПЦНГ-10 ХС
центрифужная градуированная

И.В. Трубицын г/губернатор ПЦНГ-10 ХС
центрифужная неградуированная

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Упаковщик: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг ND 

Масса нетто потребительской упаковки _____ кг

Производитель / Генератор / Выпускер: ООО «МиниМед»

Примечание: стандарт г/губернатор 1 шт в 400 до +38°C, опциональное исполнение 10 шт. Центрифужная градуированная 4 шт в 30 до +40°C, опциональное исполнение 10 шт.





НЕ БРОСАТЬ!



арт. **10005005**

74 32.50.50-038-29500133-2823

Z 4009498739557

[illegible]





поставщик лабораторий
МиниМед®

241520, Р.Ф., Бурятия обл., Буринский р-н,
с.Буринское, ул.Дзюльганова, 17а

Тел.: (4932) 92-97-97, 92-24-52 факс: 92-24-04
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Центрифужная неградуированная
ПНГ (17х105)

ГОШ Шляпы центриф. ПН-10 TC
центрифужная градуированная

ГОШ Пробирки центриф. ПН-10 TC
центрифужная неградуированная

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Упаковщик: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки _____ кг

Производитель / Оценщик / Выпускает: ООО «МиниМед»

Качество стекла при t от -40 до +60°C, химическое сопротивление при t от -40 до +60°C, механическое сопротивление на разрыв 100%.




ар. **10005008**



2 600949 335713

НЕ БРОСАТЬ!



**послестовый
лабораторий**

247528, Рб. Брянская обл., Брянский р-н,
с.Брянщина, ул.Лесовая, 17а

МиниМед®

Тел: (4832) 93-87-87, 93-34-52 факс: 93-24-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

П-1-10-0, 1ХС

100 ЛИТ/ДАНА

РР _____

ТТ 23.50.30-09-03000170-0023



Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Пентрифугируемая градуированная
ПЦП (1x100 мм)

ОБЪЕМЫ: 100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС
100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС
100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС
100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС

100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС
100мкл (0,1-0,9х10⁻⁶ л) ХС



арт.10005301



Длина нити: _____ Стерильн: _____ Упаковка: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто порового слоя: _____ г

Применение: / Обеззараж / Биотерия ООО «МиниМедПром»

Время, которое требуется для об-мк:

Время, которое требуется для об-мк:

Время, которое требуется для об-мк:



НЕ БРОСАТЬ!

Этикетки транспортной тары



поскольку
лаборатория

МиниМед®

241520, РА, Ереванская обл., Ереванский р-н,
С.Супоокас, ул.А.Давяна, 17а

Тел.: (4932) 93-47-47, 93-04-43 факс: 93-04-44
E-mail: info@minimed.am www.minimed.am



**Приборный медицинский стандартный МиниМед
Уленгута (8х40 мм)**

Шлифованный ПУ-40 Уленгута

Приборный шпатель ПУ-40 Уленгута

ПУ-40

1000 шт. (4 шт. по 250 шт.)

ПУ

ТУ 33.63.00.93-2388(13)-2002

Дата изготовления: _____ Серийный номер: _____

Масса нетто: _____ г. Масса брутто: _____ г.

Масса нетто с приборным шпателем: _____ г.

Примечания: * Физический / Визуальный ООД  

Срок годности: 5 лет с момента выпуска из производства
Срок годности: 5 лет с момента выпуска из производства
Срок годности: 5 лет с момента выпуска из производства
Срок годности: 5 лет с момента выпуска из производства

  арт. **1.0002201**





НЕ БРОСАТЬ!



**Восточная
лаборатория**

МиниМед

212120, РФ, Брянская обл., Брянск, р-н,
с.Суровское, ул.Восточная, 17а

Тел: (4852) 32-47-47, 32-48-42 факс: 32-48-64
[Email: info@mini-med.ru](mailto:info@mini-med.ru)
www.minimed.ru

Проверка медицинских стетоскопов **Minimed**
Уленгута (8х120 мм)

1) Шкала гугитера **ПУ-120 Уленгут**

2) Проверка шкалы **ПУ-120 Уленгута**

ПУ-120

400 шт./дана

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Удостовер.: _____

Масса нетто: _____ кг Масса брутто: _____ кг

Масса нетто переправочного упаков.: _____ кг

Приспособления: / Фангитер / Вспомог. ООО «МиниМед»

Важно: изделие при использовании не должно находиться в контакте с кожей человека. Запрещается использовать изделие после ТПВ.

РР _____

79 32.50.50-404-00000123-0001

арт. **10002202**



НЕ БРОСАТЬ!



постоянные лаборатории

192082, Р.Ф. Бразилия г.Бр., Бразильский рн,
с/поселение, ул.Бразилианка, 17а

МиниМед®

Тел: 8(812) 50-07-47, 50-04-62 факс: 50-04-64
E-mail: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирики медицинские стеклянные МиниМед
Биологическая (14х120 мм)

В79 Шины тупостер
биологическая ПБ2-14х120

В79 Пробирики каплевые
биологическая ПБ2-14х120

ПБ2-14х120

100 шт/упава

Дата изготовления: _____ Серий: _____ Упаковщик: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ кг

Масса нетто потребительской упаковки: _____ кг

Производитель / Импортёр / Выпускает: ООО «МиниМед»

Хранить в стерильном виде при +4 до +6°C .
вместимость воздуха внутри 100% .
Термостерилизовать при +10 до +18°C ,
влажность воздуха менее 100% .

IVD 



2 000949 753559



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

постоянный
лабораторий

241526, РФ, Брянская обл., Брянский р-н,
г.Гуляевка, ул.Дзержинского, 17а

МиниМед®

Тел.: (4832) 93-87-87, 93-24-52 факс: 93-24-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

ПБЭ-16x150

100 шт./упаковка

ТУ 32.60.50-039-2000/13-2023



**Пробирка медицинская стиллированная МиниМед
Биологическая (16x150 мм)**

550 шт./упаковка
сертификат №02-19/19

ИЗ: Рязанский институт
биомедицины №02-24-150

Длина колес., Серий: Упаковка: Масса нетто, Масса брутто: Масса нетто перепечатки/загрузки

ИВД 

ар.1.10005114

 2 606067 000000

Госрегистрация: ФГУП / Ветеринария: ООО «МиниМед»

Важно: срок годности при 25°С - 18 мес.
использовать в течение 18 мес.
После вскрытия при 2-16°С до 18 мес.
использовать в течение 18 мес.

   **НЕ БРОСАТЬ!**



**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ**



МиниМед®

с.Сухопуте, Р/В, Брянская обл., Брянский уезд,
д.Сухопуте, ур.Досюевая, 17а

Тел.: (4832) 32-47-47, 32-52-52 факс: 32-54-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Биологическая (21х200 мм)

302 Шыны түрлері
Биологиялық (21х21-смм)

302 Пробирки медицинские
Биологические (21х21-мм)

ПБ-21х200

200 шт./дана

РУ

ТУ 32.58.50-439-9808(13)-2003

Дана өзгөчө: _____ Серия: _____ Улуттук: _____

Масса китей: _____ г Масса брутто: _____ г


Масса нетто попользовательской упаковки: _____ г

Продовольствие / Прогноз / Выходные ООО «МиниМед»

Материал: стекло (тип 1) по ГОСТ 6763,
акриловый пластик (тип 2) по ГОСТ 15458,
поликарбонат (тип 3) по ГОСТ 15458,
металлический пластик (тип 4) по ГОСТ 15458.




арт. 10005207



НЕ БРОСАТЬ!

МиниМед

поставщик лабораторий

341200, РФ, Брянская обл., Брянский р-н,
с.Смоленск, ул.Знаменная, 17а

Тел.: (4832) 93-8747; 93-24-62 факс: 93-24-64
e-mail: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Химическая (14x120 мм)

ПХ1-14х120

500 шт./ДАНА

RU Шлифы тугоплавкие ПХ1-14 х120 RU Пробирки химические ПХ1-14 х120

Дата ввезен.: _____ Серий: _____ Упаковщик: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г [ND] ⚠

Масса нетто потребителям упаковки: _____

Производитель: JSC "Optical" / Зав.-произв. ООО «МиниМед»

Примечание: материал корпуса из АБС до +100°C, оптическое стекло класса ВВВ. Прочностные свойства при t=+100°C до +100°C, механические свойства класса ВВВ.

⚠ ⚠ ⚠ НЕ БРОСАТЬ! 2 0009498739397

арт. 10002814

 **поставщик
лабораторий**

МинусМед®

291538, РФ, Брянская обл., Брянский р-н,
с.Орловское, ул.Школьная, 17а

Тел.: (48353) 694147, 69-3642 факс: 69-36-94
Email: info@minusmed.ru www.minusmed.ru

Губерния медицинские стеклянные Иммобилайзеры

Выидаль (10x105 мм)

№ Шины туплер ГВБЗ-10х105 Визиде

№ Губерия медицинская ГВБЗ-10х105 Визиде

ГВБЗ-10х105

500 шт./упаковка

ТУ 32.04.00-408-00000079-0003

Дата изготовления _____ Срок _____ Удостоверение _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто партия/сертификат упаковки _____ кг

Грузополучатель / Грузовик / Выпускник ООО «МинусМед»

Адрес склада при входе на МРП:
м.Брянск, станция метро «Спутник»,
Транспортный проезд №1 стр.48-к.48Ф.

Итого: 10002301

НЕ БРОСАТЬ!



**национальный
лаборатори**

МиниМед

241510, Р.Б. Брестская обл., Брестский р-н,
г.Брест, ул.Григорьевская, 173

Тел.: (8032) 62-61-67, 62-26-62 факс: 62-26-64
E-mail: info@minimed.by minimed@minimed.by

Пробиотик кишечной стафилококковой флоры
Сериологическая (10х120 мм)

PC2-10х120

400 шт/упаковка

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУ

71 173 100-6100-00000170-00003

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Упаковка: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто по сертификату качества: _____ г

Производитель: **Фармацевтический завод «МиниМед»**

апр. 10002506



**постоянные
лаборатории**

МиниМед®

241028, РР, Братская обл., Братский р-н,
с.Сумыно, ул.Московск., 17а

Тел.: (4832) 80-07-47, 80-34-52 факс: 80-34-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

**Пробирки медицинские стеклянные МиниМед
Серологическая (12х75 мм)**

PC2-12x75

250 шт./дмч

ИД Шыны тастары PC2-12x75 _____
 ИД Серологиясы PC2-12x75 _____
 ИД Пробиркасы PC2-12x75 _____
 Сигнатура _____

Дата выдачи: _____ Серия: _____ Упаковка: _____

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г

Масса нетто переполненной упаковки _____ г **IVD** ⚠

Производитель / Импортёр / Выпускатель ООО «**МиниМед**»

Адрес склада при вводе на сайт:

«Посылочный склад» при вводе на сайт «МФЦ»,
 «Братский» филиал адрес: _____

⚠ ⚠ ⚠ НЕ БРОСАТЬ! ⚠ ⚠ ⚠

 арт. 00000000



**Восточные
лаборатории**



281203, РФ, Ярославль обл., Ярославль р-н,
С.Бунинское, ул.Школьная, 179

Тел.: (4832) 310-01-81, 81-04-62 факс: 81-04-64-64
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Проверен медицинскими специалистами Минимед
Серодиагностическая (12х100 мм)
ИИ: Шылы кутырыс ПС3-12х100
Серологическая
ИИ: Рауыберй кыстыны ПС3-12х100
Серологическая

ПС2-12х100

250 шт./упаковка

РР _____

ТТ ХХ/ХХ/ХХ-ХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХ

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Номер: _____

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г

Максимум к переиспользованию, если _____

Противопоказания: / Ограничения / Вспомогательные вещества отсутствуют

Срок годности при 2-8 °С до 18 мес.

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +25 °С.



НЕ СРОКАТЬ!



[illegible]



лаборатория

МиниМед

211620, Рб. Белорусия мбн, Беларусь р-н,
г.Супрунов, уаdБелорусия, 17а

Пробирки медицинские стандартные Полилад
Флоринского (12х60 мм)

БС Шлипы тушлатур Флоринского ПХХ1-12х60

ИП Пробирки шлитные Флоринского ПХХ1-12х60

Тел.: (8082) 8047-47, 80-04-80 факс: 80-04-80
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

ПХХ1-12х60

450 шт./дз.дз.

РУ 73.02.04.04-02-00007133-2023

Дата кал.: _____ Серия: _____ Упаковка: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто погубительной упаковки _____ кг

Продукция (Ф)Флоринского ООО «МиниМед»

Важно! Не бросать! Не бросать! Не бросать!




ap.10002707





Министерство
Здравоохранения
Республики Беларусь



МуніМед

341510, Мн., Братская ул., Братская ст.
с.Сучовича, ул.Дзюльскага, 17а

Тел.: (8032) 92-97-47, 92-94-02 факс: 92-94-64
Email: info@muni-med.ru



Пробирка медицинская стеклянная **МуніМед**
Флоринского (14х60 мм)

ХИМический состав: Фторинского ПНБЗ-СА-02

ИЗГОТОВЛЕНО в соответствии с требованиями ГОСТ 1-14-68

ПФХ1-14х60

300 шт/упаковка

РУ 12.94.85-439-300818-13-3023

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Исполнитель: _____

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г

Масса нетто-таргетированной упаковки _____ г




Полное наименование (в упаковке): Фторинского ООО «МуніМед»

Примечание: материал упаковки не содержит вредных веществ, содержание фтора 99%, температура плавления 100°C.




НЕ БРОСАТЬ!

AP1.10002708



2 005479 733474





поставщик лабораторий

241200, РФ, Белгородская обл., Белгород, р-н,
д.Суровское, ул.Белгородская, 17а

МиниМед

Тел: (4832) 93-87-87, 93-84-52 факс: 93-24-54
E-mail: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Мерная со шлифом 5 мл

БСБ Шлифов трубочек медицинская

сертификат ПМ2-5-10/19

ПМ-2-5-10/19

60 шт. (6 шт. по 10 шт.)

ИЗ: Пробирки стеклянные медицинские со шлифом ПМ2-5-10/19

Дата изгот. _____ Серия: _____ Упаковщик: _____

Масса нетто _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто потребительской упаковки _____ г

Производитель: ООО «МиниМедПром»

Исполнитель: ООО «МиниМедПром»

Изготовлено, одобрено после 1 из 48 дт 19/03/

массовая влажность не более 0,5%,

Прозрачность: после 1 из 48 дт 19/03/

всплывающий пузырь не более 100%.

ру _____

ТУ 32.90.50-636-29508133-2023

арт. **10002411**



2 0009498733203

   **НЕ БРОСИТЬ!**

ИВД 

 **Министерство здравоохранения Республики Беларусь** **МиниМед**[®]

241520, Р/р. Брестская обл., Брестский р-н, с. Суховича, ул. Школьная, д. 17а
Тел. (4852) 10-41-47 факс 10-44-51 E-mail: info@mini-med.by www.mini-med.by

Пробион медицинский стерилизированный МиниМед
Мерная со шлифом (с пробкой) **5 мл**

ПМ-2-5-10/19

РУ _____ ТУ 32.50.50-430-29500113-2023

Дата изготовления _____ Срок годности _____ **60** шт.

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г

Масса нетто порционной упаковки _____ г **(6 шт. по 10 шт.)**

Производитель: ООО «МиниМедПром»

Импортер: ООО «МиниМедПром»

Хранить в закрытом при 10°С до 40°С

Хранительский период не более 18 мес.

Транспортировать при 10°С до 40°С

Хранительский период не более 18 мес.

10002412



2 000470 392621



поставщик лабораторий

МиниМед

341518, РД, Боровская обл., Боровской р-н,
зд.15/20, ул.И.Савина, 17а

МиниМед

Тел: (4432) 52-47-41, 52-54-52 факс: 52-54-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Мерная со шлифом 5 мл

ООО «Шлиф» густитель органики
сертификат ПМЗ-5-14/23

ООО «Граблер» доставляет материалы
по сертификату ПМЗ-5-14/23

Дата изготовления: _____ Серия: _____ Удостоверение: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто потребительской упаковки: _____ г

Производитель: ООО «МиниМед»
Исполнитель: ООО «МиниМедПром»

Упаковка: колпачки при 1 от -80 до +40°C,
вакуумировано внутри мешка 95%
Температура: при 1 от -80 до +40°C,
вакуумировано внутри мешка 95%

ПМ-2-5-14/23

60 шт. (6 уст. по 10 шт.)

RV

ТУ 32.50.50-039-29900133-0223

арт. 10002410



210009498739212



НЕ БРОСАТЬ!

 **МиниМед**
Продукция медицинского назначения
 241520, РД, Бирюковская обл., Бирюковский р-н, с. Сукконово, ул. Шоссейная, д. 17а
 Тел.: (4932) 10-64-47 факс: 10-64-64 E-mail: info@minimed.ru www.minimed.ru

Продукция медицинского назначения МиниМед
Мерная со шлифом (с пробой) **5 мл**

ПМ-14/23

РУ _____ ТУ 32.50.50-50-29960133-0023

Дата выг.: _____ Серия _____ Удостовер.: **60** шт.
 Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г (8 шт. по 10 шт.)
 Масса нетто погребальной упаковки: _____ г

Продукция: ООО «МиниМед»
 Производитель: ООО «МиниМедПром»

Хранить изделие при t от -40 до +40 °С.
 Гарантийный срок хранения 36 мес.
 Транспортировать, хранить и использовать изделие при t от -40 до +40 °С.
 Влажность воздуха не более 75%.

 арт. 10002401



   **НЕ БРОСАТЬ!**



лаборатория MuniMed

341520, РФ, Брянская обл., Брянский р-н,
с. Сухиничи, ул. Ю.И.Жуковского 17а

MuniMed

Тел. (4832) 95-67-67, 95-24-62 факс: 95-69-64
Email: info@muni-med.ru www.muni-med.ru



Пробирки медицинские стеклянные MuniMed

Мерная со шлифом 10 мл

ПМ-2-10-14/23

60 шт. (6 укл. по 10 шт.)

ВНИМАНИЕ! Гигиеническая упаковка
сертификат ПМЗ-10-14/23

ВНИМАНИЕ! Шлифованный мерный
стекло шлифом ПМЗ-10-14/23

ру

ТУ 32.96.89-63-29908133-0023

Длина нити: _____ Сортик: _____ Утолщение: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто потребительской упаковки: _____ г

арт. 10002406

Производитель: ООО «MuniMedPlus»

Исполнитель: ООО «MuniMedПром»

Хранить, хранить при t от -40 до +30°C

вместимость упаковки не менее 95%,

транспортировать при t от -40 до +30°C

вместимость упаковки не менее 95%.

ИД



НЕ БРОСАТЬ!





2 600949739229

восточный лабораторий **МиниМед®**

241520, Ряз. Брянская обл. Брянский р-н, с. Сухоинов, ул. Школьная, д.17а
Тел. (4832) 92-04741 факс 92-04-541 e-mail info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирик медицинские стеклянные МиниМед

Мерная со шрифтом (с пробой) **10 мл**

ПМ-2-10-14/23

РУ _____ ТУ 32.38.50-030-300008133-0023

Дате изгот. _____ Срок: _____ Указания: _____ **60 шт.**

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г **(9 шт. по 10 шт.)**

Масса нетто потребительской упаковки _____ г

Промышленность: ООО «**МиниМед**»
Идентификация: 000 **10002402**

Хранить следует при t от +4 до +18°С, относительной влажности воздуха не более 75%.

Транспортировать, хранить при t от +4 до +18°С, относительной влажности воздуха не более 75%.

ИД **А**

НЕ БРОСАТЬ!

2 00060407300001



постоянный лабораторий

241020, РН, Бокане рб, Бокане р-н,
с/поселение: ушайовичи, 17а



Тел: (832) 93-97-47, 93-24-02 факс: 93-24-04
Email: info@muni-med.ru www.muni-med.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Мерная со шлифом 15 мл

ВНИ: Шлифованный открытый
каталог: ПМ2-15-14/23

ВНИ: Пробирки цветные шлифованные
со шлифом ПМ2-15-14/23

ПМ-2-15-14/23

60 шт. (6 р. по 10 шт.)

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Удостовер.: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто потребительской упаковки: _____ г

Продавец: ООО «МиниМедПром»

Исполнитель: ООО «МиниМедПром»

Класс, соответствующий ГОСТ 8-89 до 1984 г.

Химическая чистота не менее 99,9%

Температурный коэффициент расширения при 20-80 °C до 100°C

Химическая выдержка не менее 100%

rv

ТУ 32.56.00-039-29500153-0023

арт. 10002407



2 600949739236





НЕ БРОСАТЬ!



постоянный лабораторий

МиниМед

Тел.: 8(383) 33-67-67, 33-24-62
факс: 33-24-64
e-mail: info@minimed.ru

Пробирки медицинские стеклянные МиниМед

Мерная со шлифом 25 мл

002 Шлифы: тушечек эмалево-шрифтовых ПМБ-25-16/22

003 Пробирки: шлифовые мерные со шрифтом ПМБ-25-14/23

ПМ-2-25-14/23

60 шт. (6 укл. по 10 укл.)

Дата изгот.: _____ Серия: _____ Упаковка: _____

Масса нетто: _____ г Масса брутто: _____ г

Масса нетто потребительской упаковки: _____ г

Производитель: ООО «МиниМед»

Исполнитель: ООО «МиниМед»/Пресс

Хранит., срок годности — 40 лет при +5...+25°C

вместимость изделия менее 100 мл

Термостойкость при t от -60 до +60°C

химическая стойкость к щелочам

гг. YY XX.98.50-438-296061133-30023

арт. 10002409







НЕ БРОСАТЬ!



**вспомогательная
лаборатория**



241520, Р.Б. Брестская обл., Брестский р-н,
с.Сумаслово, ул.Школьная, 17а

Тел.: (4832) 85-47-47, 85-54-52 факс: 85-24-64
E-mail: info@minimeat.ru www.minimeat.ru

Проверенные международные стандарты МиниМед
С заворачивающейся крышкой
13х13х100 мм

100 шт/упаковка

ПЗК-13х100

100 шт/упаковка

№ **77 32.80.30-028-20000173-3623**

Дата изготовления: _____ Серийный номер: _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг **IVD** 

Масса нетто холодильной упаковки _____ кг

Производитель: / Изготовитель / Выпускает: ООО «МиниМед»

Срок годности: 12 месяцев при температуре от +5 до +25°C
 при температуре хранения от +5 до +25°C
 при температуре хранения от +5 до +25°C

П **И** **И** **НЕ БРОСАТЬ!**

арт. **00000000**



[illegible]



**научно-исследовательский
лабораторий**

МиниМед

241920, Р.Ф. Бразовая обл., Бразовый р-н,
с.Суровское, Удальцовское, 17а

Тел.: (4832) 93-87-47, 93-26-54
Email: info@minimed.ru www.minimed.ru

Пробирки лабораторные стеклянные МиниМед

Агглютинационная (9х80 мм)

№5 Шпигуль PA-98 Агглютинационная

№9 Пробирки оксаловые PA-989 Агглютинационная

ПА-9х80

100 шт./упак

Дата экзп.: _____ Серия: _____ Удальцовск: _____

Масса нетто _____ г Масса брутто _____ г

Масса нетто лабораторной упаковки _____ г

IVD 

Производитель: / Изготовитель: ООО «МиниМед»

Примечание: изделие не подлежит повторному использованию

Примечание: при использовании изделия в качестве лабораторной упаковки для ИВД, необходимо соблюдать следующие правила:

НЕ БРОСАТЬ!

апр.000000000

 **посетимся
лабораторий** **МиниМед®**

241528, РФ, Брянская обл., Брянский р-н, с.Супонинское, ул.Шоссейная, 17а
Тел.: (48328) 92-07-07, 92-24-53, 92-24-53, -55, -56 факс: 92-24-54, 92-06-94

Проверим и подтвердим стабильность МиниМед

Колориметрическая (17х205 мм)

ПК-17х205

100 шт/упаковка

100 шт/упаковка

РР

ТУ 92.00.00-00-000000-000000

Дата ввода _____ Серия _____ Удостоверение _____

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг

Масса нетто/масса брутто/масса упаковки _____

IND 

Российская Федерация / Беларусь / Украина: ООО «МиниМед»

МиниМед® — торговый знак ООО «МиниМед»

МиниМед® — торговый знак ООО «МиниМед»

   **НЕ БРОСАТЬ!**

арт. 000000000



В.Р. Азбукин