

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДНК ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА (CMV) МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«АМПЛИПРАЙМ® CMV» ПО ТУ 21.20.23-095-09286667-2020


Макеты этикеток

Лист утверждения

4/10

Макеты этикеток

для набора реагентов для выявления и количественного определения
ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в
режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV»
по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

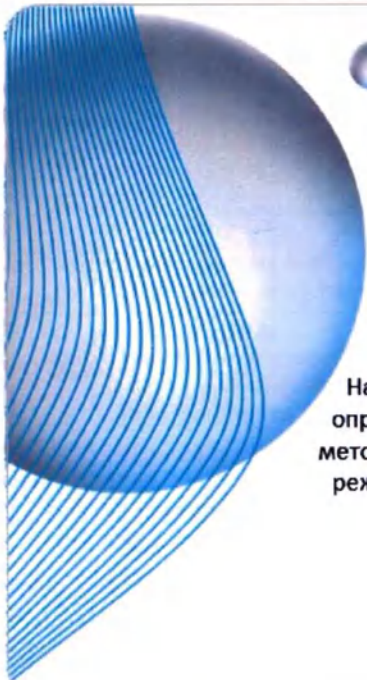Наименование этикетки/реагента	Макет этикетки																																
Набор (лицевая сторона)	  АмплиПрайм® CMV Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020 																																
Набор, форма 1 (оборотная сторона)	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020 <table><tr><td>Форма выпуска 1</td><td>REF X</td><td>Σ 100</td><td> 2 °C  8 °C </td></tr><tr><td>Состав набора:</td><td></td><td></td><td>LOT ХДДММГГYY</td></tr><tr><td>ПЦР-смесь CMV</td><td>0,01 мл × 100 пробирок</td><td></td><td> ГТГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>ПЦР-буфер-К</td><td>1,20 мл × 1 пробирка</td><td></td><td> ГТГГ-ММ-ДД</td></tr><tr><td>K1 HS</td><td>0,12 мл × 1 пробирка</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K2 HS</td><td>0,12 мл × 1 пробирка</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ОКО</td><td>1,10 мл × 1 пробирка</td><td></td><td></td></tr><tr><td>К-</td><td>0,26 мл × 1 пробирка</td><td></td><td></td></tr></table> Только для диагностики <i>in vitro</i> Для профессионального применения Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73  ООО «НекстБио» Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2 тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг 	Форма выпуска 1	REF X	Σ 100	 2 °C  8 °C 	Состав набора:			LOT ХДДММГГYY	ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок		 ГТГГ-ММ-ДД	ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка		 ГТГГ-ММ-ДД	K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка			K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка			ОКО	1,10 мл × 1 пробирка			К-	0,26 мл × 1 пробирка		
Форма выпуска 1	REF X	Σ 100	 2 °C  8 °C 																														
Состав набора:			LOT ХДДММГГYY																														
ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок		 ГТГГ-ММ-ДД																														
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка		 ГТГГ-ММ-ДД																														
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка																																
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка																																
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка																																
К-	0,26 мл × 1 пробирка																																

**Набор, форма 2
(оборотная
сторона)**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020


Форма выпуска 2

REF X

Σ 100

Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	1,20 мл × 1 пробирка
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
К-	0,26 мл × 1 пробирка



LOT ХДДММГТТ

ГТТ-ММ-ДД

ГТТ-ММ-ДД

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг



**Набор, форма 3
(оборотная
сторона)**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020


Форма выпуска 3

REF X

Σ 100

Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
К-	0,26 мл × 1 пробирка



LOT ХДДММГТТ

ГТТ-ММ-ДД

ГТТ-ММ-ДД

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг



**ПЦР-смесь
EBV, форма 1**

АМПЛИПРАЙМ

ПЦР-смесь CMV

0,01 мл × 100 пробирок

REF XXXX

LOT XXXX

ГТТ-ММ-ДД



**ПЦР-смесь
EBV, форма 2**


АМПЛИПРАЙМ

ПЦР-смесь CMV

1,20 мл

REF XXXX **LOT** XXXX

ГТТ-ММ-ДД



ПЦР-смесь
EBV, форма 3

AMPLIPRIME

ПЦР-смесь CMV

0,01 мл × 100 пробирок
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-буфер-Н,
форма 2

AMPLIPRIME

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-буфер-К,
форма 1, 3

AMPLIPRIME

ПЦР-буфер-К

1,20 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



K1 HS

AMPLIPRIME

K1 HS

0,12 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



K2 HS

AMPLIPRIME

K2 HS

0,12 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ОКО

AMPLIPRIME

ОКО

1,10 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



К-

AMPLIPRIME

К-

0,26 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



Пронумеровано, скреплено и прошито
4 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»


М. Е. Сенина



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДНК ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА (CMV) МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«АМПЛИПРАЙМ® CMV» ПО ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Транспортная маркировка

Лист утверждения

Маркировка транспортной тары

для набора реагентов для выявления и количественного определения
ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией
в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV»
по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»


Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ___ / Количество мест ___

Грузополучатель

Пункт назначения

Условия транспортирования и хранения



Не допускается замораживание реагентов.
Допускается транспортирование при температуре от
8 до 25 °C не более 3 суток.

Масса нетто наборов реагентов ___ кг

Масса брутто ___ кг

Манипуляционные знаки



Верх



Беречь от влаги

Хрупкое. Осторожно

Приложение №2
к договору поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина

« 28 » 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Набор реагентов выпускается в 3 формах:

Форма выпуска 1 в составе:

1. ПЦР-смесь CMV – 0,01 мл x 100 пробирок
2. ПЦР-буфер-К – 1,20 мл x 1 пробирка
3. K1 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
4. K2 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
5. ОКО – 1,10 мл x 1 пробирка
6. К- – 0,26 мл x 1 пробирка

Форма выпуска 2 в составе:

1. ПЦР-смесь CMV – 1,20 мл x 1 пробирка
2. ПЦР-буфер-Н – 0,65 мл x 1 пробирка
3. K1 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
4. K2 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
5. ОКО – 1,10 мл x 1 пробирка
6. К- – 0,26 мл x 1 пробирка

Форма выпуска 3 в составе:

1. ПЦР-смесь CMV – 0,01 мл x 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)¹
2. ПЦР-буфер-К – 1,20 мл x 1 пробирка
3. K1 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
4. K2 HS – 0,12 мл x 1 пробирка
5. ОКО – 1,10 мл x 1 пробирка
6. К- – 0,26 мл x 1 пробирка


Комплектность набора:

1. Набор реагентов (форма выпуска 1, 2 или 3)
2. Инструкция по применению набора в электронном виде² на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде
4. Комплект вкладышей к набору в бумажном виде
5. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru

¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

**I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

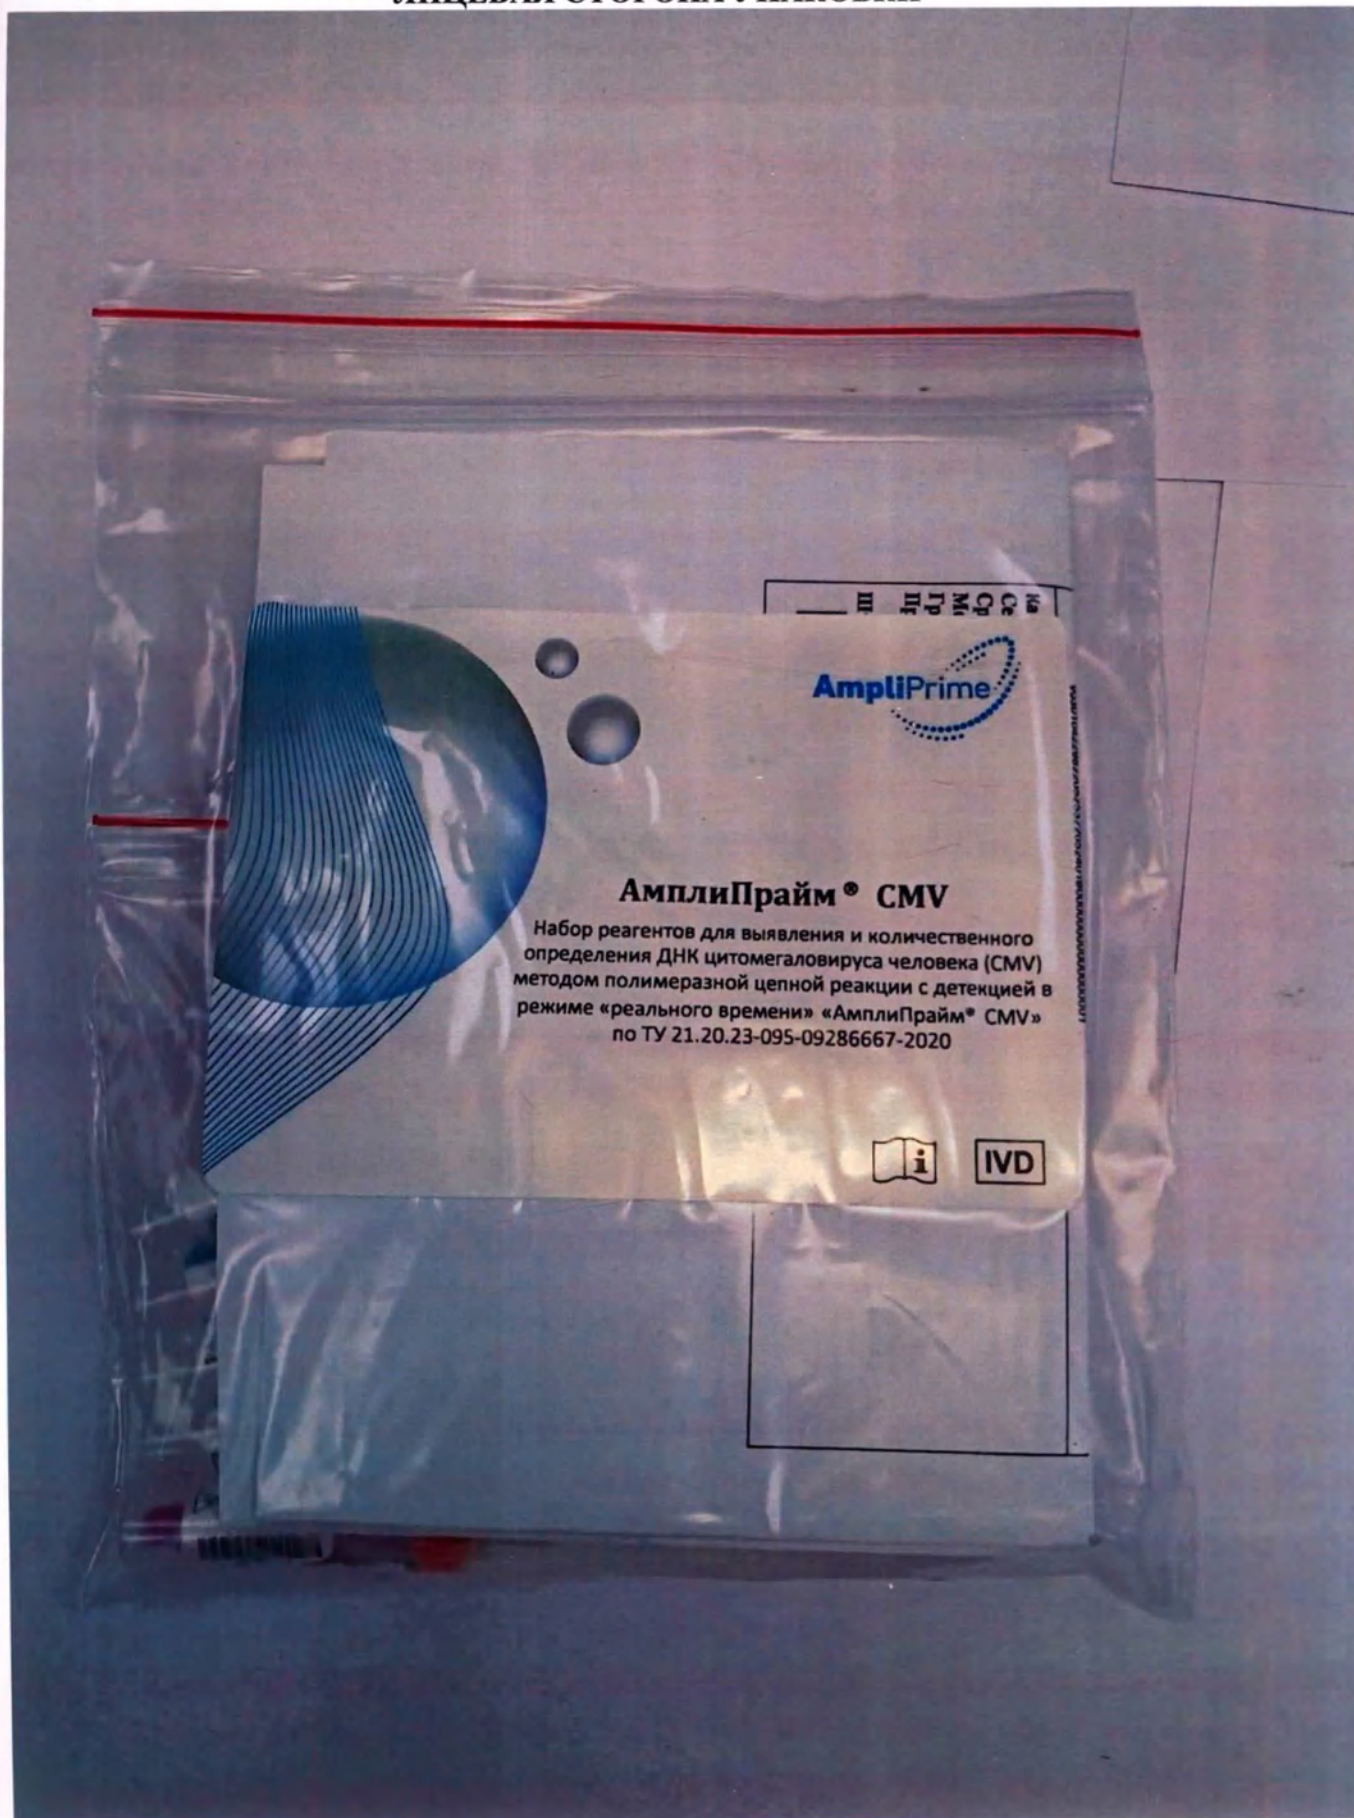

**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 1

REF P2054-41

Σ 100

Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
К-	0,26 мл × 1 пробирка

2 °C 8 °C

LOT 322052401

2024-05-22

2025-05-22

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг



PRIME

2025-08-20

2 °C 8 °C



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

НекстБио

Внимание!

АмплиПрайм® CMV

Упаковка для хранения и транспортировки

Информация о продукте и условиях хранения

Срок годности: 2025-05-22

Группа совместимости: АмплиПрайм (ДНК ВГ)

Пробирки: 1000-Стекло Q

Штрих-код

Группа совместимости: АмплиПрайм (ДНК)

№: 12054-41

Срок годности: 2025-05-22

Упаковка: 1000-Стекло Q

Группа совместимости: АмплиПрайм (ДНК ВГ)

Пробирки: 1000-Стекло Q

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код

Штрих-код



Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

АмплиПрайм® CMV

Форма выпуска 1

REF 12054-41

ООО «НекстБио», Россия, 111384,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
т. (495) 620-08-73, факс: 620-08-74

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 1

REF 12054-41

Состав набора:

ПЦР-смесь CMV

ПЦР-буфер-х

81 HS

82 HS

CMV

В:

0,01 мл × 100 пробирок

1,0 мл × 1 пробирка

0,12 мл × 1 пробирка

0,12 мл × 1 пробирка

0,24 мл × 1 пробирка

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru

Печать партии

Дату по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»

Россия, 111384, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

т. (495) 620-08-73, факс: 620-08-74

www.nextbio.ru

ИНН 50/010/0000000

ОГРН 1045000000000

КПП 50/010/0000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000


С/ОГР 1045000000000

С/ОГР 1045000000000




ПЦР-смесь CMV
0,01 мл × 100 пробирок
REF 5515 LOT 0005
2025-08-20
AMPLIPRIME


«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
СОСТАВ

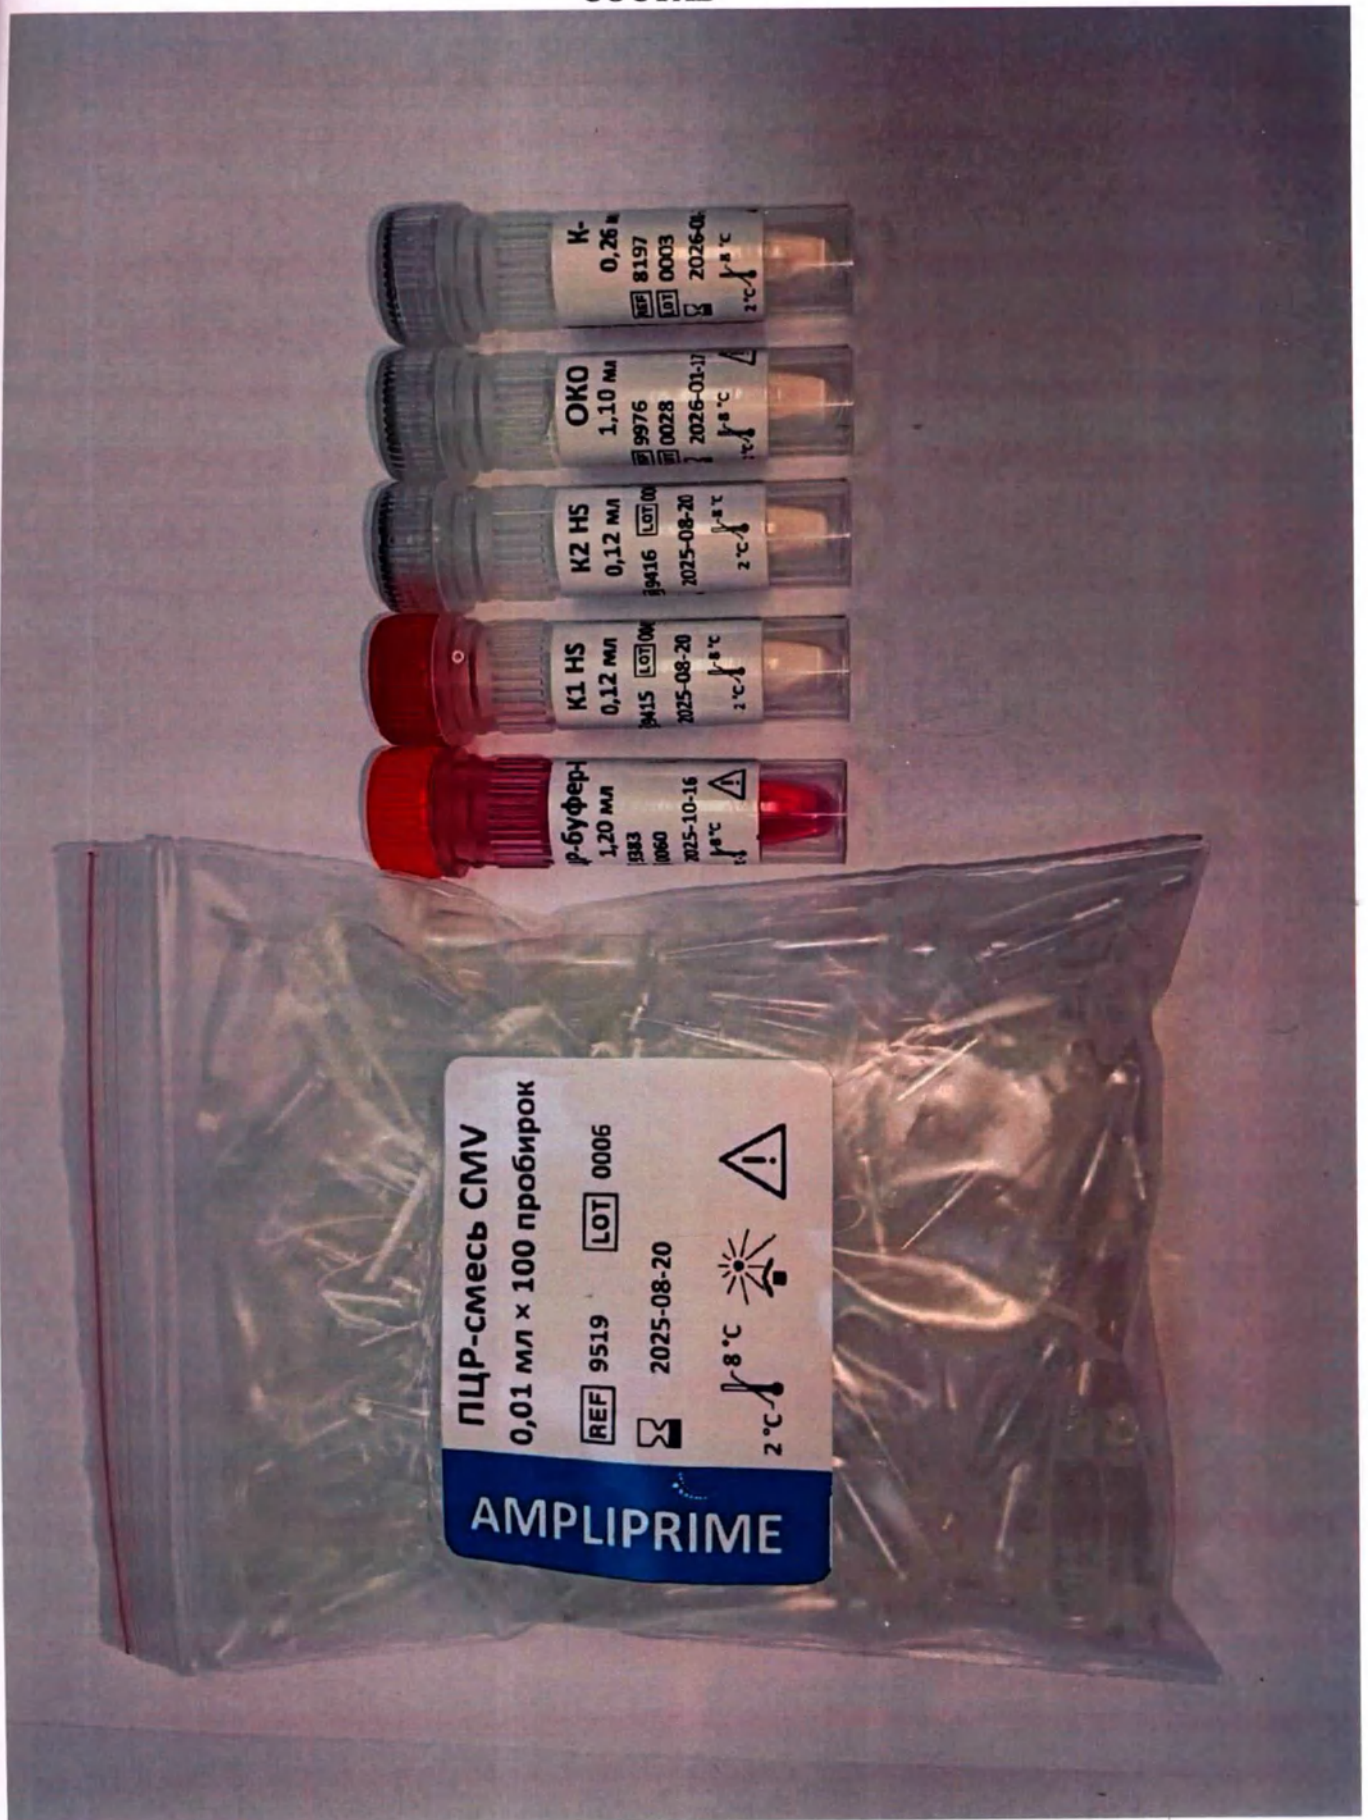

«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

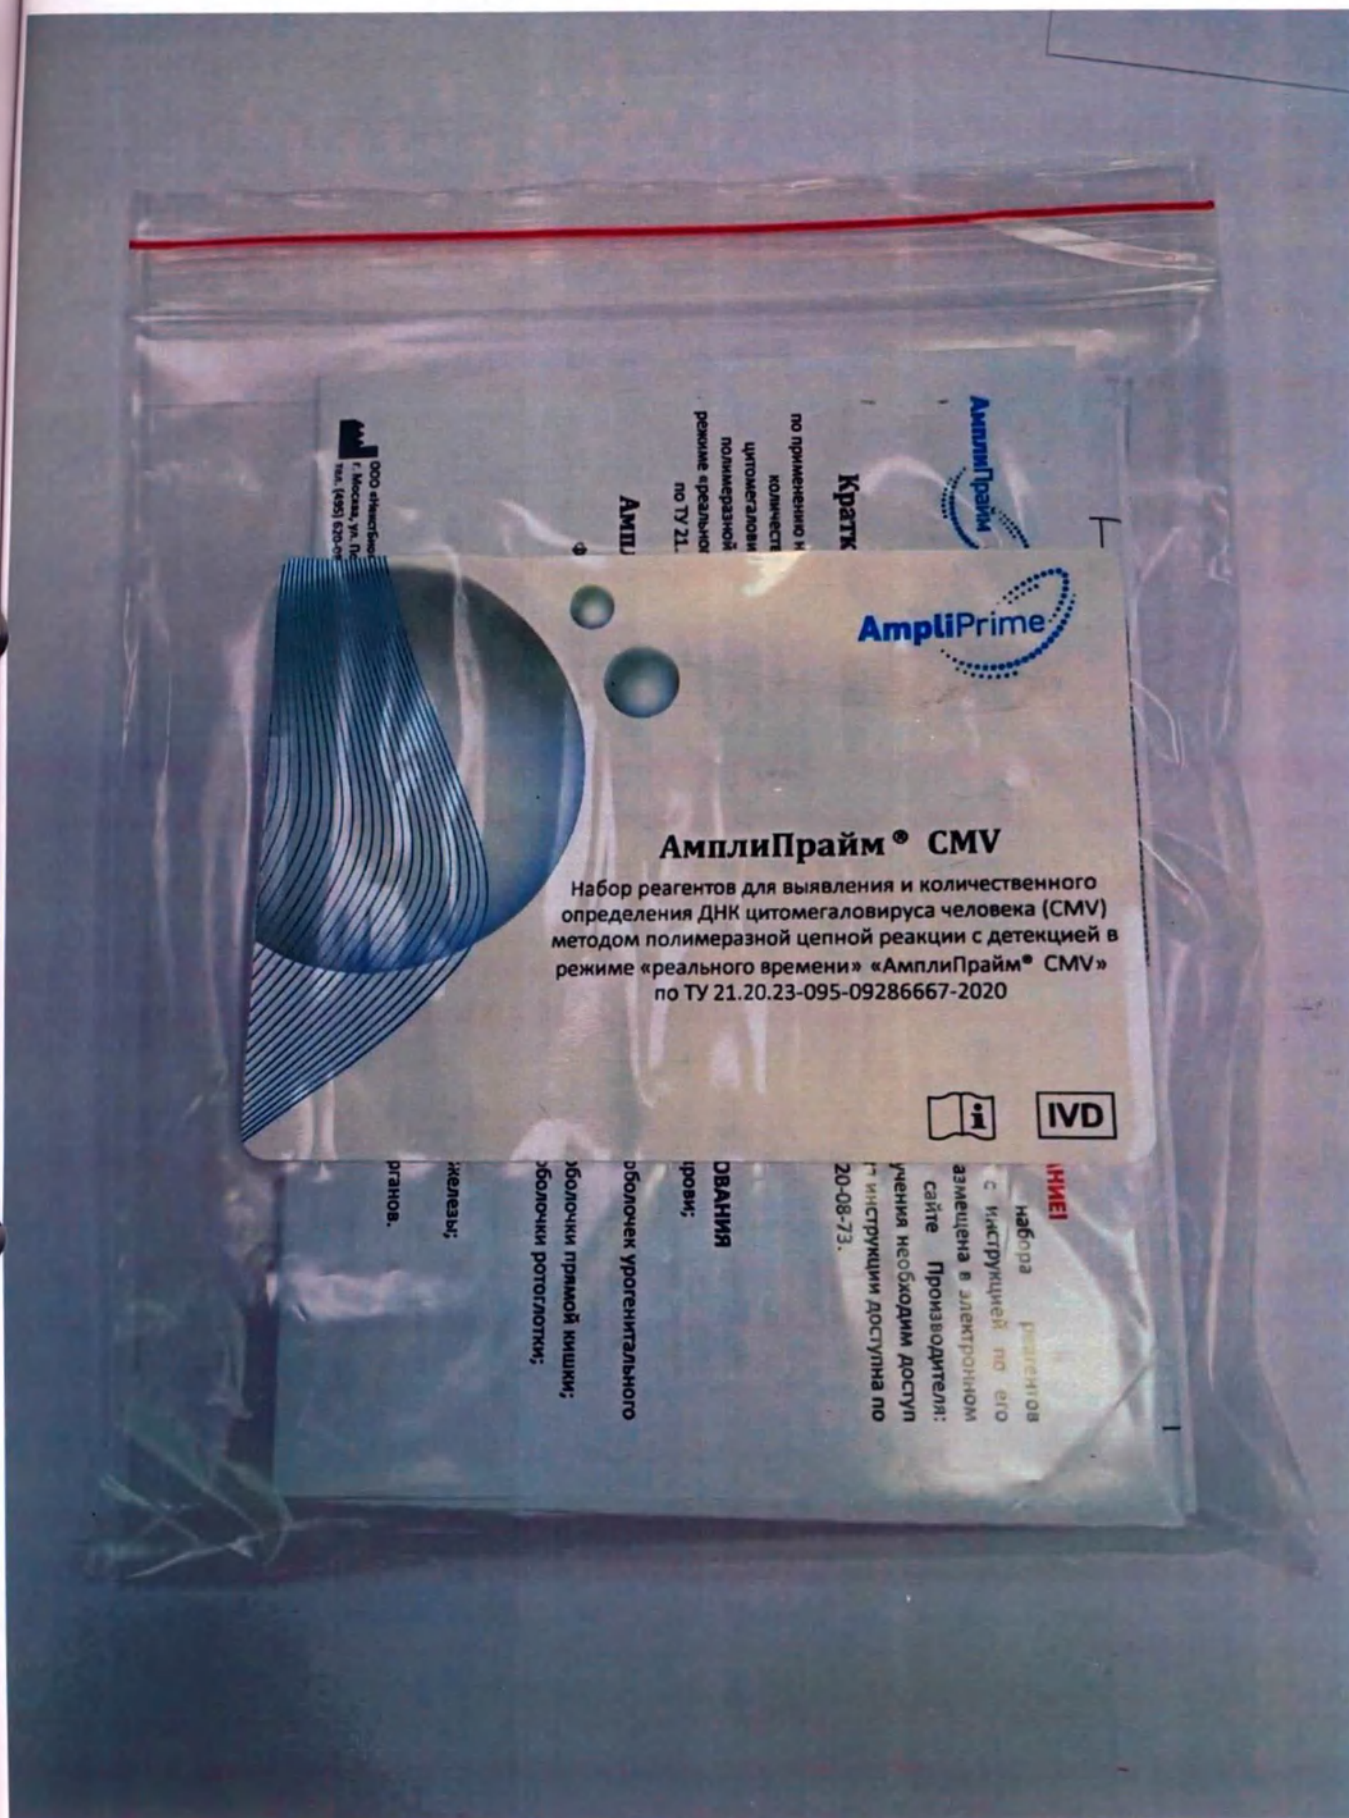

«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



ООО «НекстБио», Россия, 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2,
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК
цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 2

REF 2054-42

100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	1,20 мл × 1 пробирка
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
K-	0,26 мл × 1 пробирка

LOT 322052402

2024-05-22

2025-05-22

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения


Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.мм.гггг



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

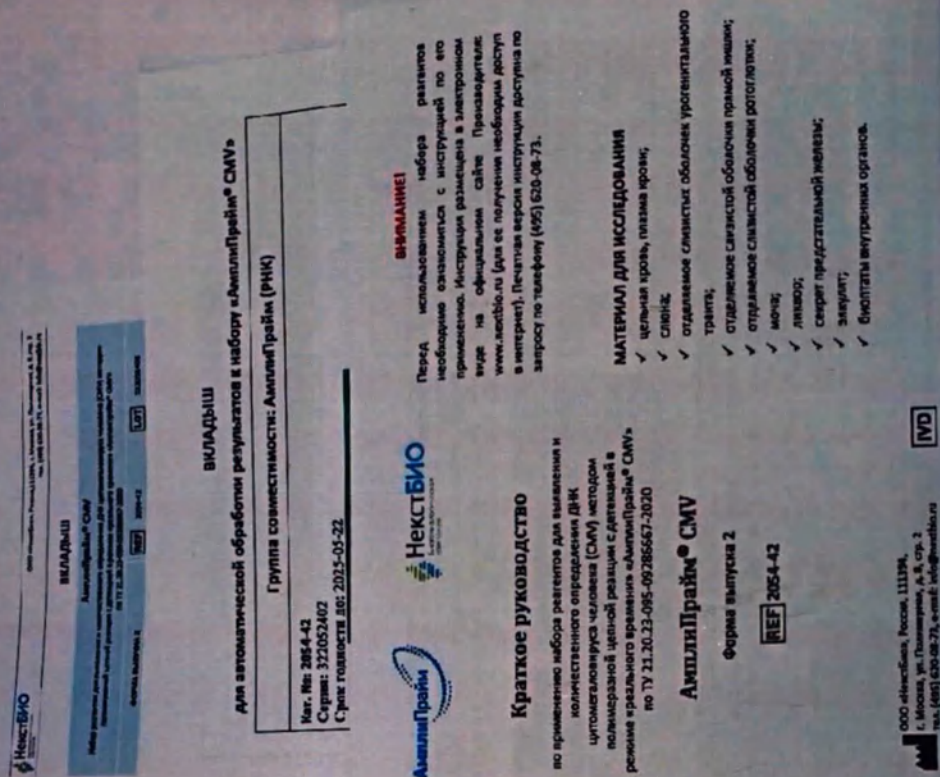

«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
СОСТАВ

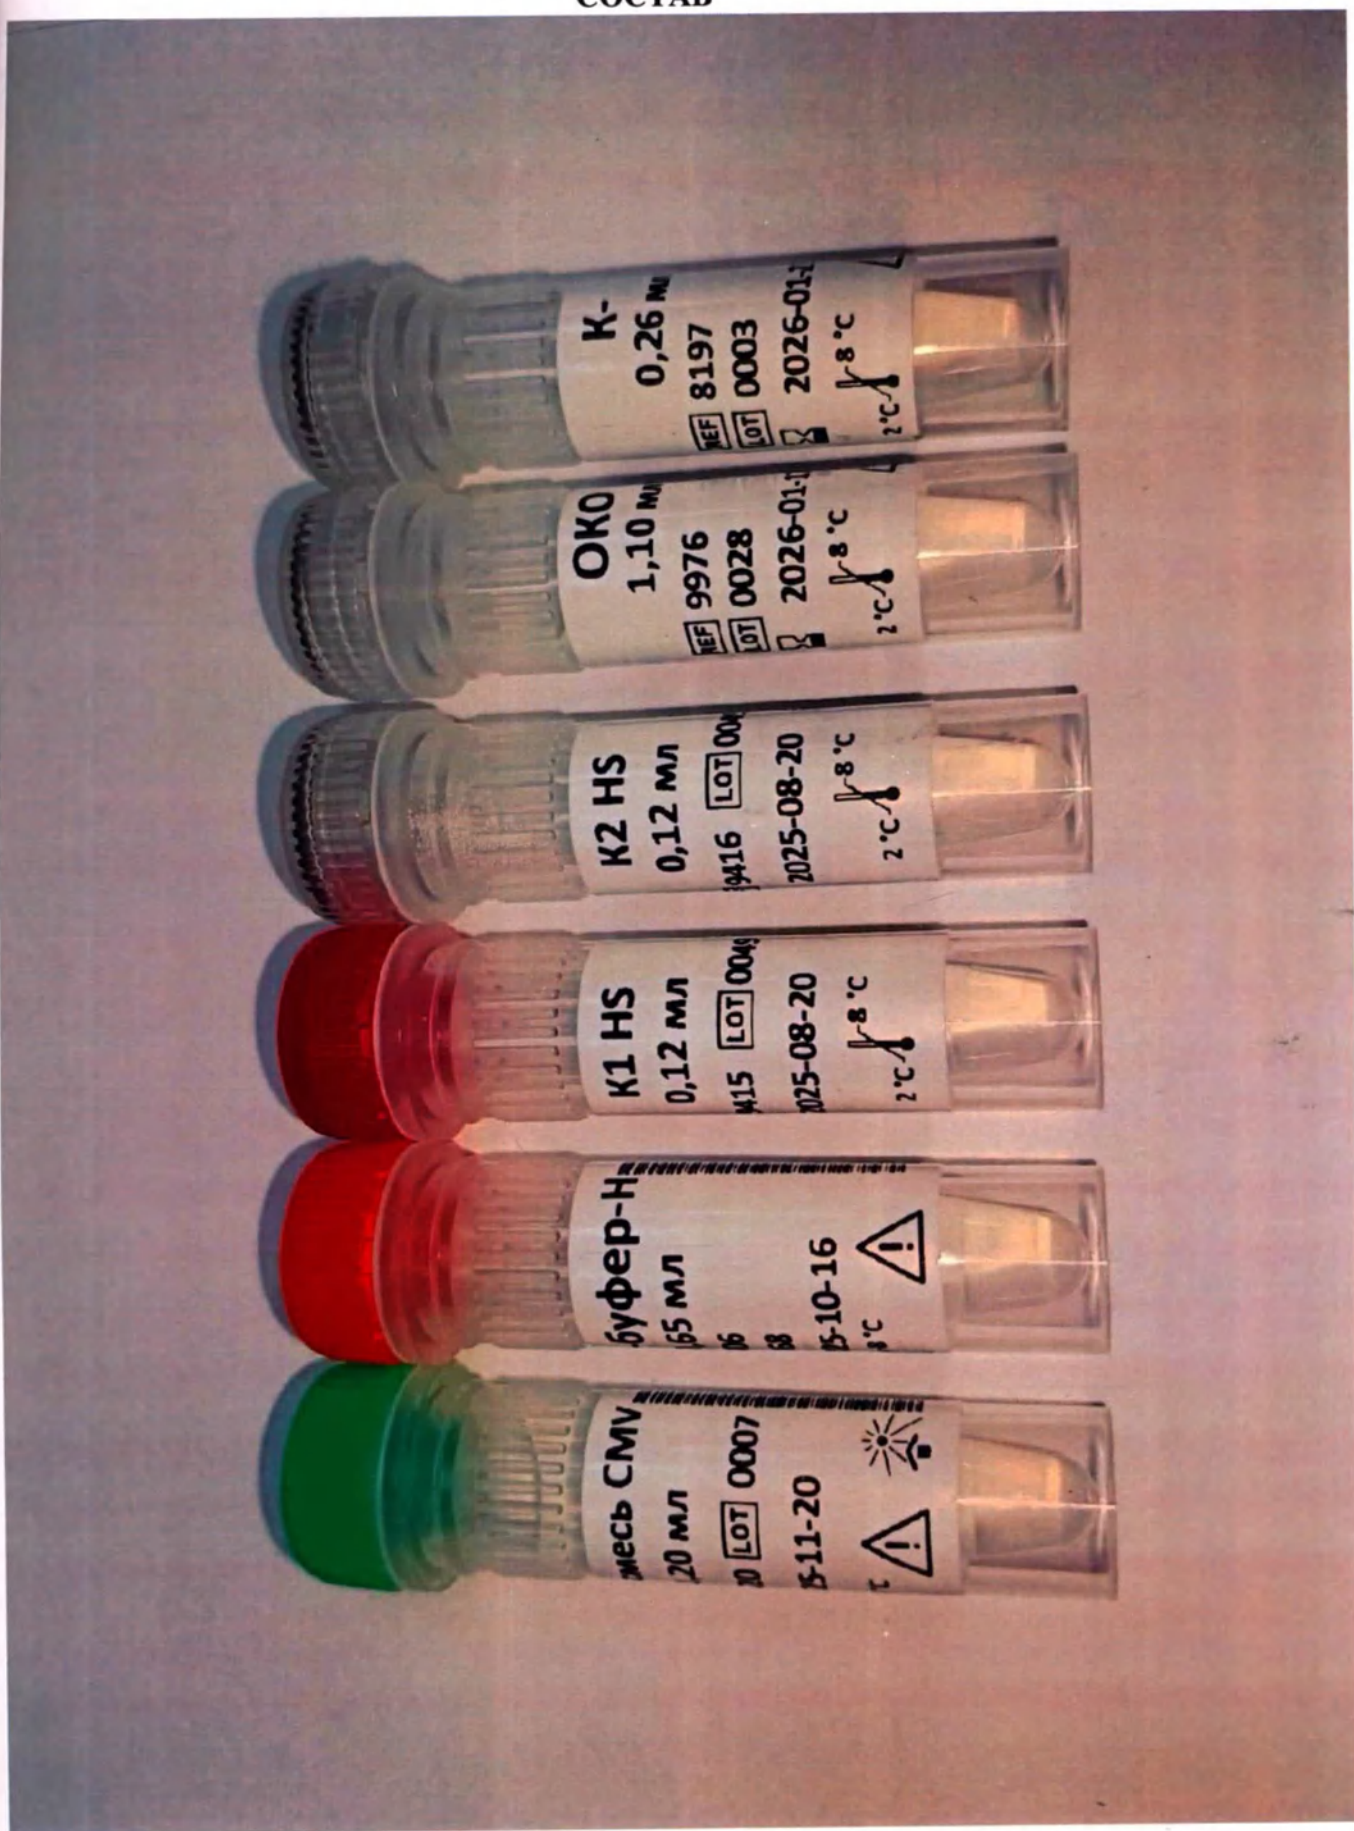


«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
СОСТАВ

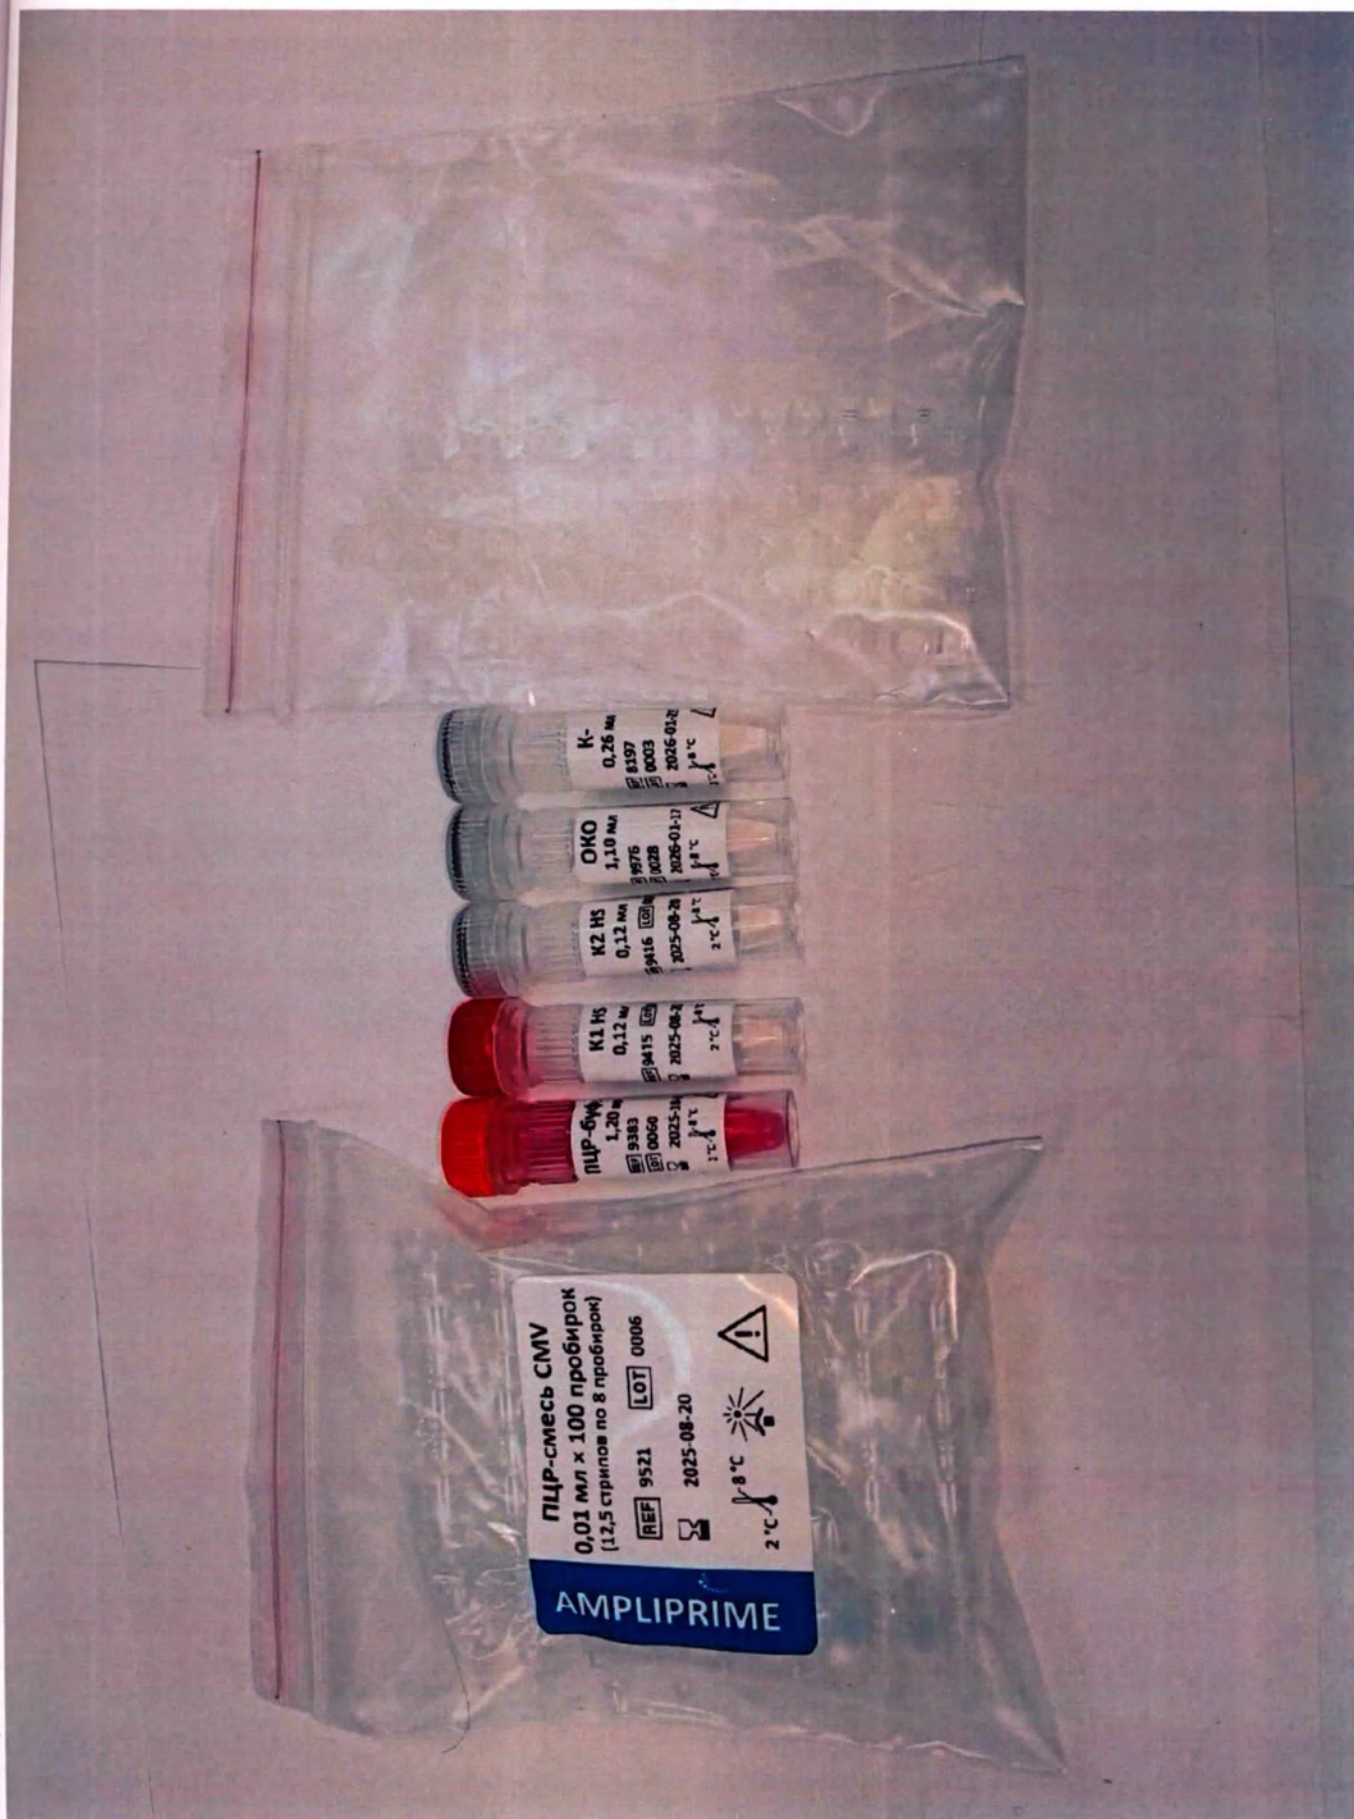

**II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 1

REF P2054-41

100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок
ПЦР-буфер-К	1,20 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
К-	0,26 мл × 1 пробирка

LOT 322052401

2024-05-22

2025-05-22

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73





ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН xxxx/xxxx от dd.mm.yyyy



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

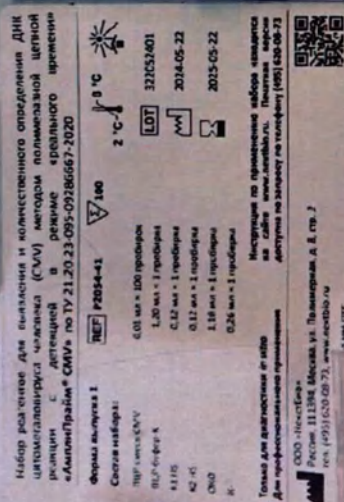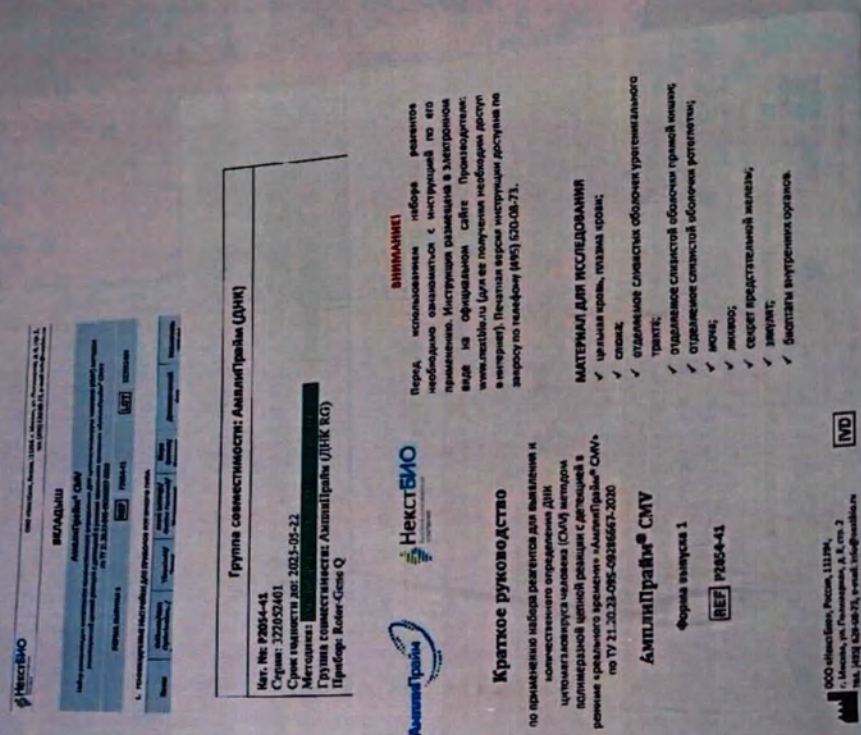

«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 1
СОСТАВ



**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 2

REF 2054-42

Σ 100

2 °C 8 °C

Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	1,20 мл × 1 пробирка
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОНО	1,10 мл × 1 пробирка
К-	0,26 мл × 1 пробирка

LOT 322052402

2024-05-22

2025-05-22

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг




«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



ВКЛАДЫШ
Для автоматической обработки результатов и набору «АмплиПрайм® CMV»

Группа совместимости: АмплиПрайм (РНК)
Ид. №: 2054-42
Серия: 322052402
Срок годности: до 2025-05-22



ВНИМАНИЕ!
Перед использованием набора результатов необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Инструкция размещена в электронном виде на официальном сайте производителя: www.nektarbio.ru (для ее получения необходим доступ в интернет). Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 626-08-71.

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 11.20.23-095-09786667-2020

АмплиПрайм® CMV

форма выпуска 2

REF: 2054-42



ООО «НекстБио», Россия, 121394, г. Москва, ул. Промышленная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 626-08-71, e-mail: info@nektarbio.ru

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 11.20.23-095-09786667-2020

Форма выпуска 2	REF: 2054-42	100	2 °C	8 °C	LOT: 322052402	2024-05-22	2025-05-22
Состав набора:							
ПЦР-смесь CMV	1,20 мл × 1 пробирка						
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл × 1 пробирка						
K1-HS	0,12 мл × 1 пробирка						
K2-HS	0,12 мл × 1 пробирка						
DNase	1,10 мл × 1 пробирка						
W	0,26 мл × 1 пробирка						

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения


ООО «НекстБио»
Россия, 121394, Москва, ул. Промышленная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 626-08-71, www.nektarbio.ru
ТУ 11.20.23-095-09786667-2020



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 2
СОСТАВ



**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

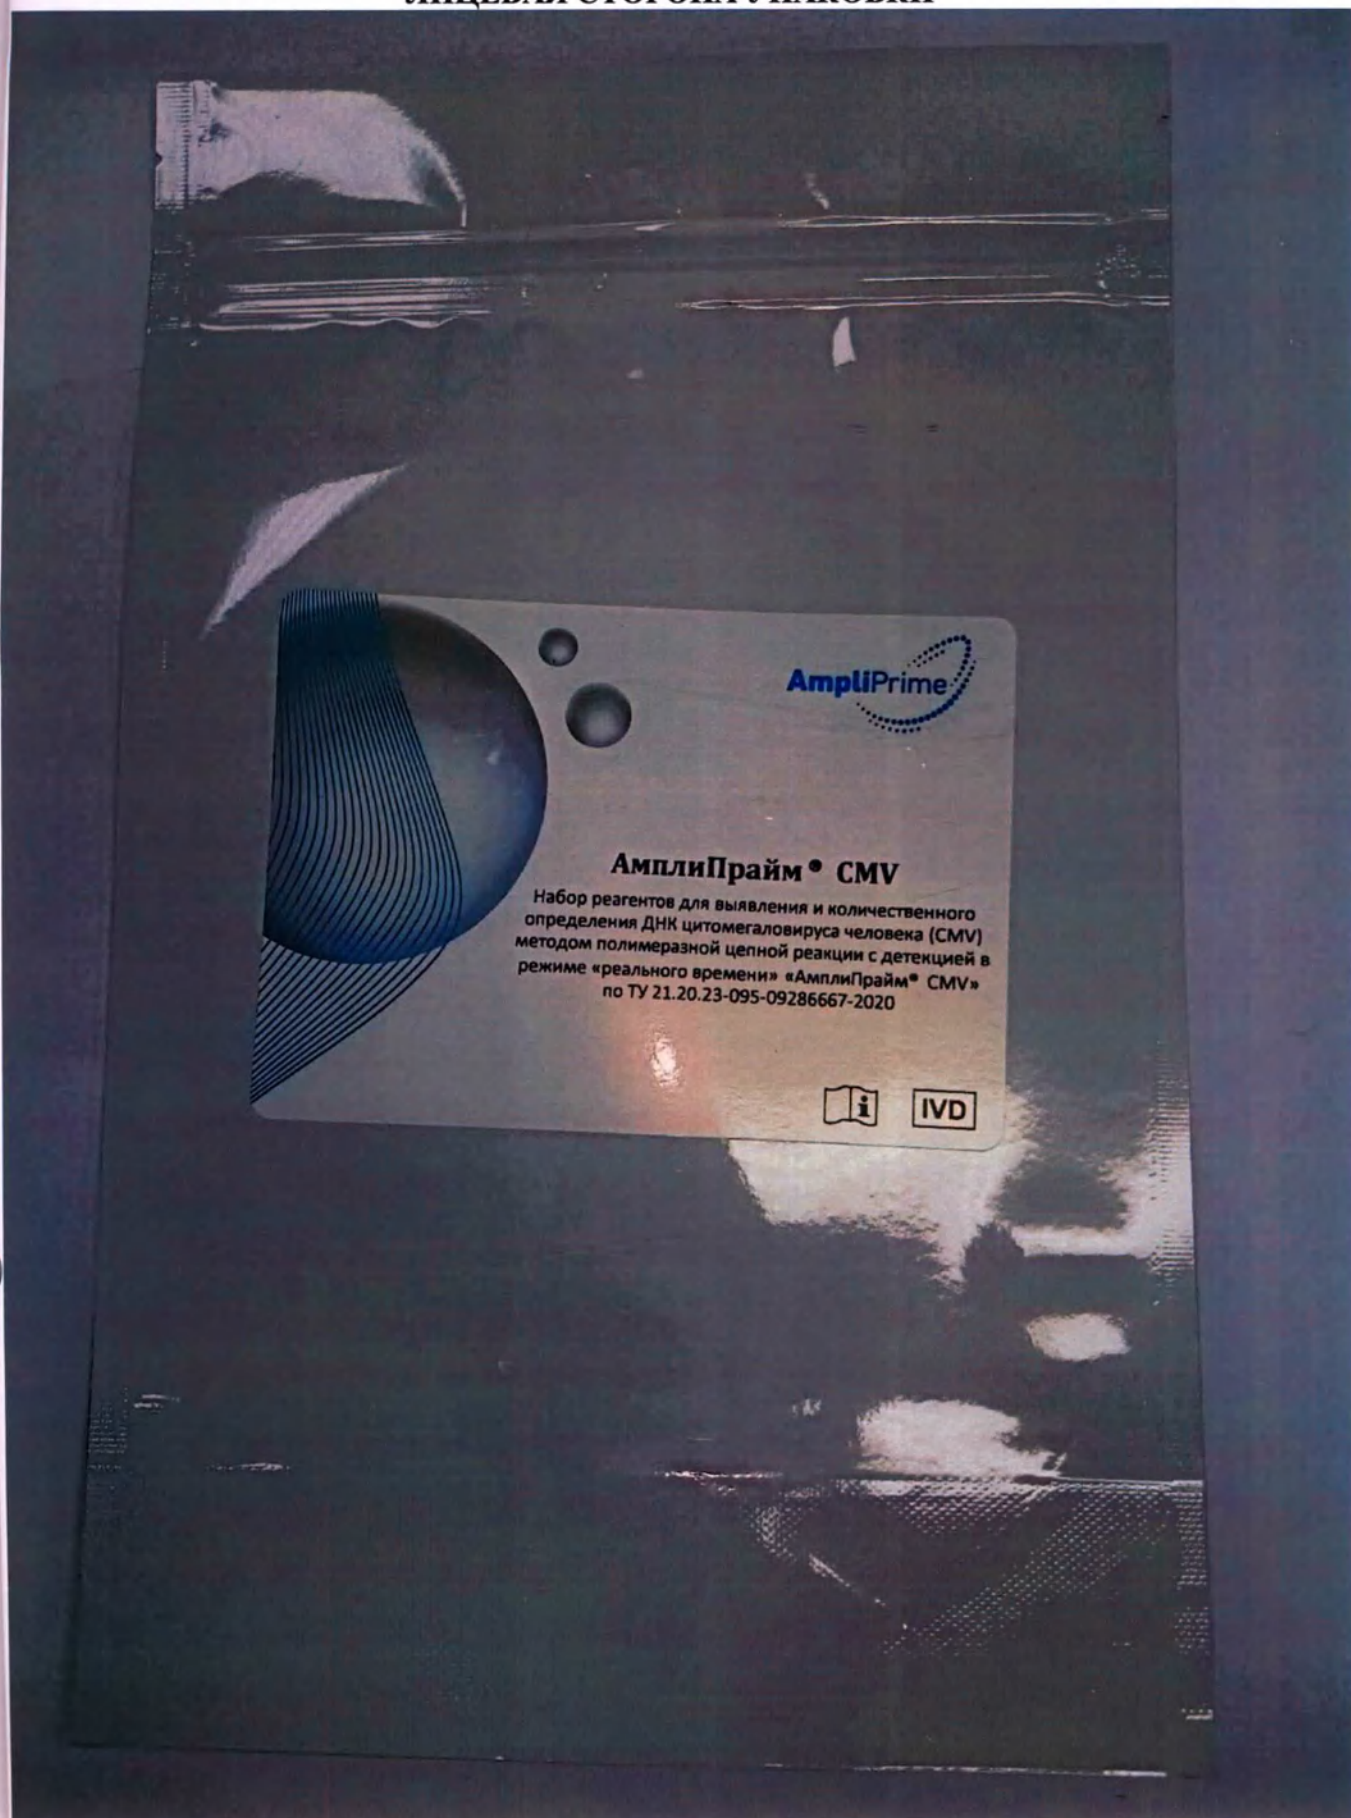

**«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09286667-2020

Форма выпуска 3

REF P2054-43

Σ 100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь CMV	0,01 мл × 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)
ПЦР-буфер-K	1,20 мл × 1 пробирка
K1 HS	0,12 мл × 1 пробирка
K2 HS	0,12 мл × 1 пробирка
ОКО	1,10 мл × 1 пробирка
K-	0,26 мл × 1 пробирка

LOT 322052403

2024-05-22

2025-05-22

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг



«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

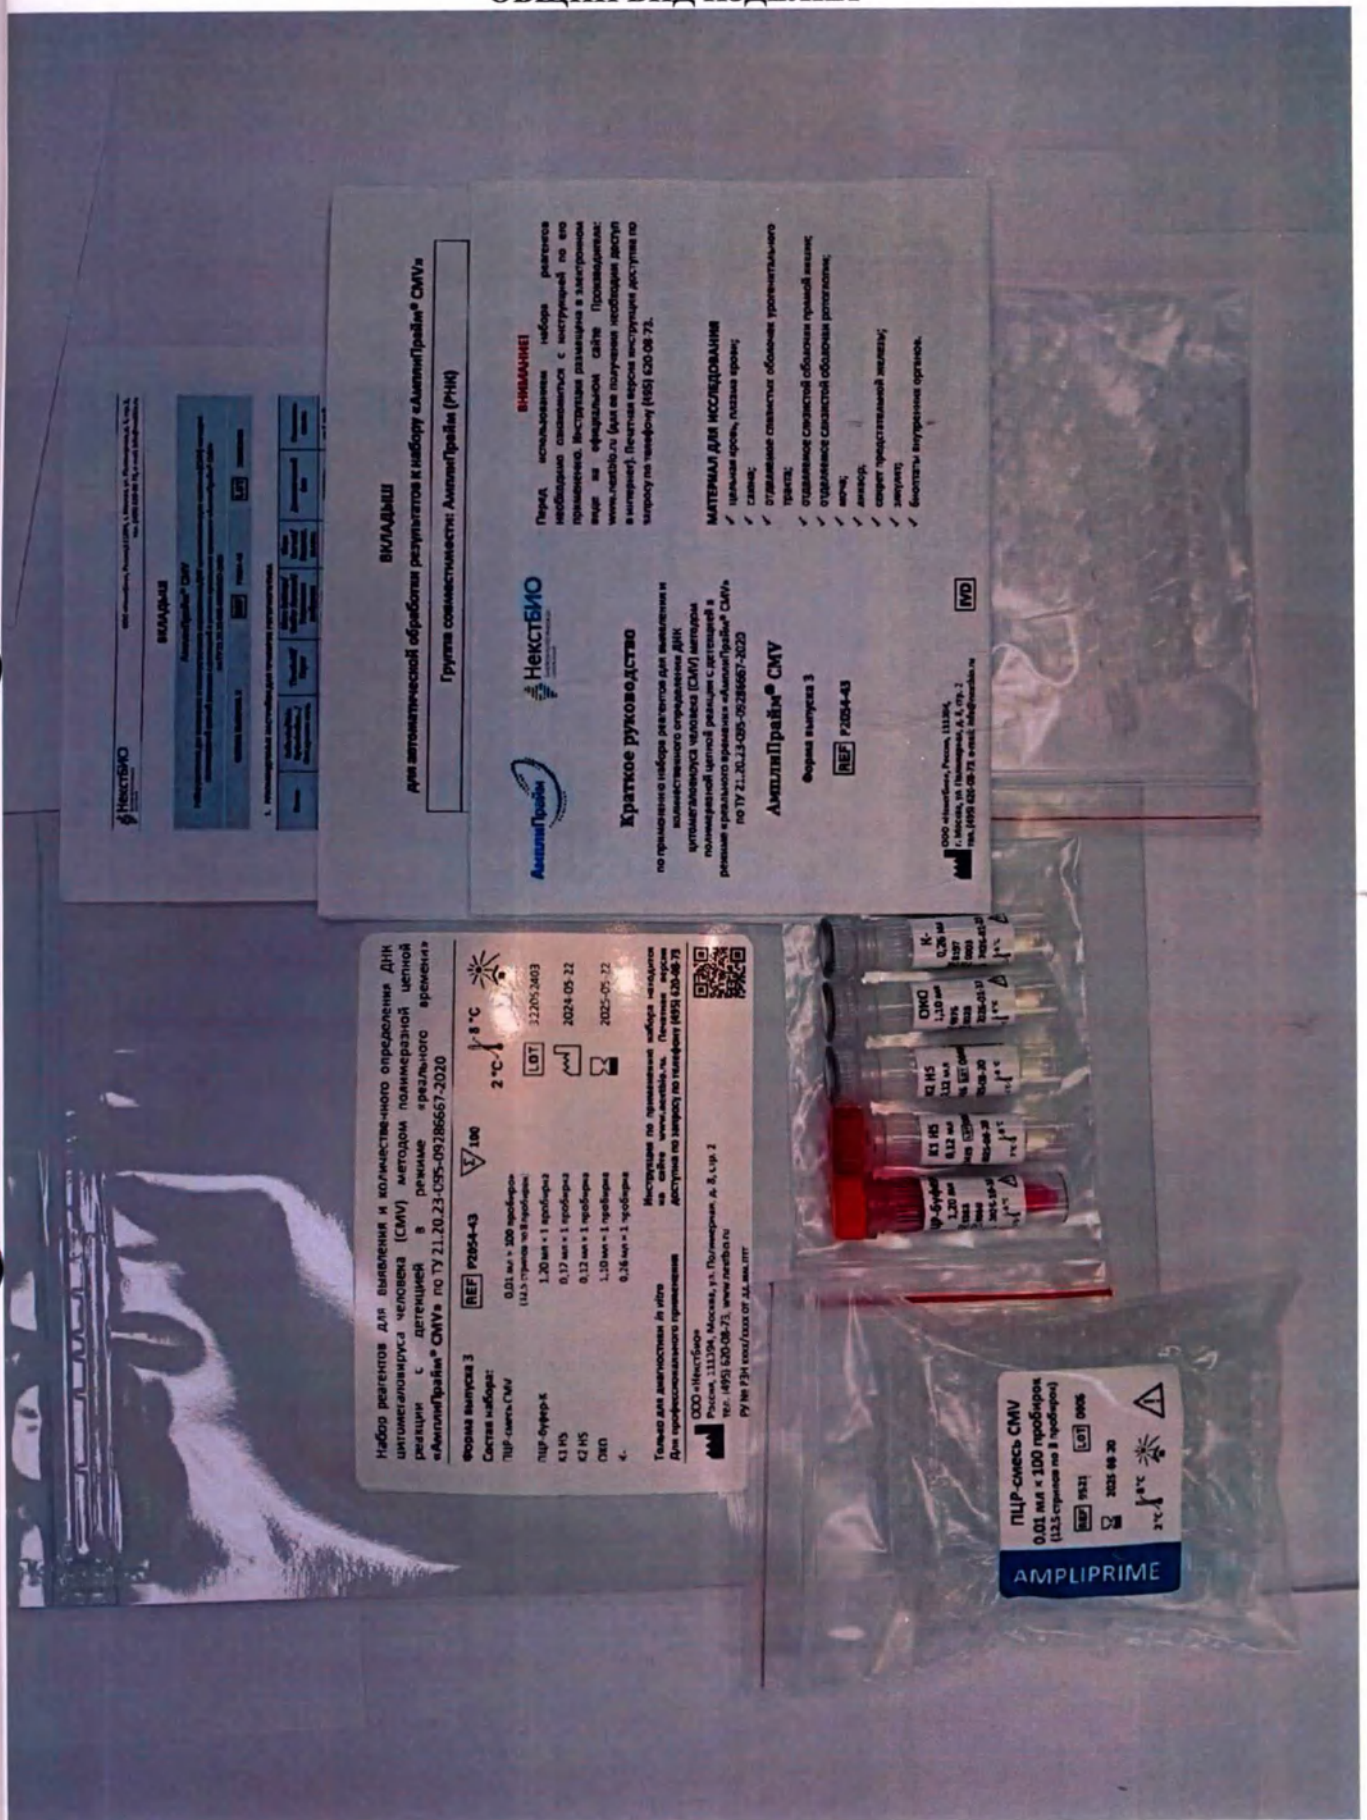

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09/86667-2020

Формы выпуска 3
Система набора:
ПЦР-смесь CMV
ПЦР-буфер-к
41 HS
42 HS
CMV
4.

0,01 мл × 200 пробирок
(12,5 пробирок × 8 пробирок)
1,20 мл × 1 пробирка
0,17 мл × 1 пробирка
0,12 мл × 1 пробирка
1,10 мл × 1 пробирка
0,24 мл × 1 пробирка

2°C, 8°C
LOT 32205-2403
2024-05-22
2025-05-22

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nektbio.ru. Печать на сайте.
Для профессионального применения
Доступен по телефону по телефону 8(495) 620-08-73

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел.: 8(495) 620-08-73, www.nektbio.ru
RU № РЗМ 1001/2020 от 22.04.2020



ПЦР-смесь CMV
0,01 мл × 100 пробирок
(12,5 пробирок × 8 пробирок)
LOT 32205-2403
2024-05-22
2025-05-22
AMPLIPRIME

ВКЛАДЫШ
Для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® CMV»
Группа совместимости: АмплиПрайм (РНН)

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием набора реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Инструкции размещены в электронном виде на официальном сайте производителя: www.nektbio.ru (для ее получения необходимо доступ в интернет). Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону 8(495) 620 08 73.


МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
✓ цельная кровь, плазма крови;
✓ слюна;
✓ отделяемые секреты: обильное утреннее слюноотделение;
✓ трахеальный секрет;
✓ отделяемое слизистой оболочки прямой кишки;
✓ отделяемое слизистой оболочки ротоглотки;
✓ моча;
✓ ликвор;
✓ секрет предстательной железы;
✓ запиты;
✓ биопаты внутренних органов.

Краткое руководство
по применению набора реагентов для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® CMV» по ТУ 21.20.23-095-09/86667-2020

АмплиПрайм® CMV
Формы выпуска 3
REF P2054-43

ООО «НекстБио», Россия, 111394,
Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел.: 8(495) 620-08-73, www.nektbio.ru

«АмплиПрайм® CMV», форма выпуска 3
СОСТАВ

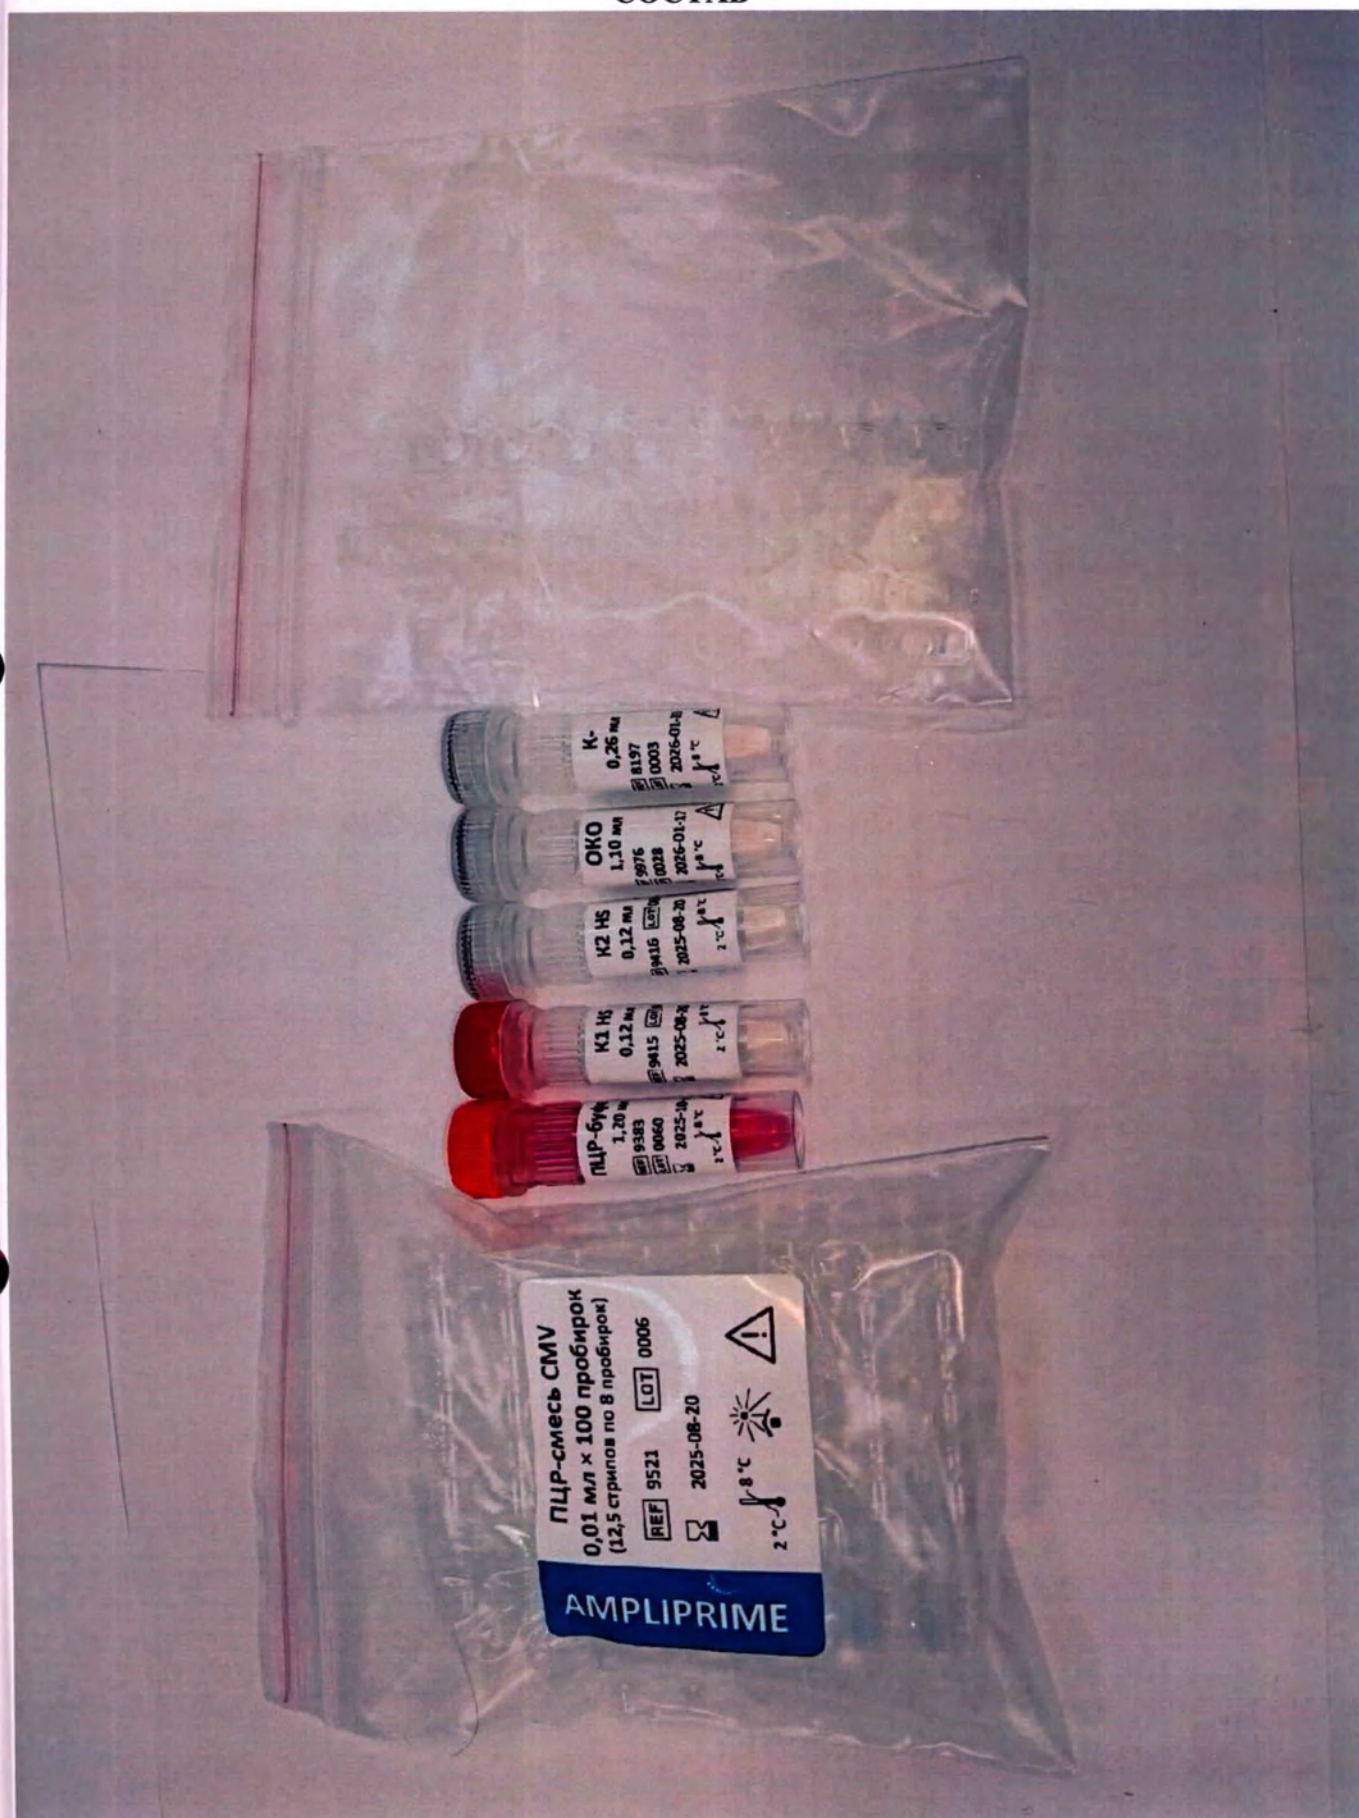

III. Транспортная тара
Термоконтейнер одноразового использования. ОБЩИЙ ВИД.



A green canvas bag with a white label and a black and white illustration of a person's face. The bag is made of a heavy, textured material and has a large, flat top. The label is rectangular and contains text in Russian, including "Условия транспортирования", "не подвергать воздействию влаги", and "Масса нетто". The illustration is a stylized, high-contrast drawing of a person's face, possibly a man with a mustache, looking forward. The bag is shown against a dark background.

Пронумеровано, скреплено и прошито
28 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НексБио»

М.Е. Сенина

