

**Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф
«АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009**

**Комплект фотографических изображений
ЮМГИ.941541.016-03 Д**

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	2 из 30




Фотографическое изображение 1 – Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009 (общий вид)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	3 из 30



Фотографическое изображение 2 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (вид спереди)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	4 из 30

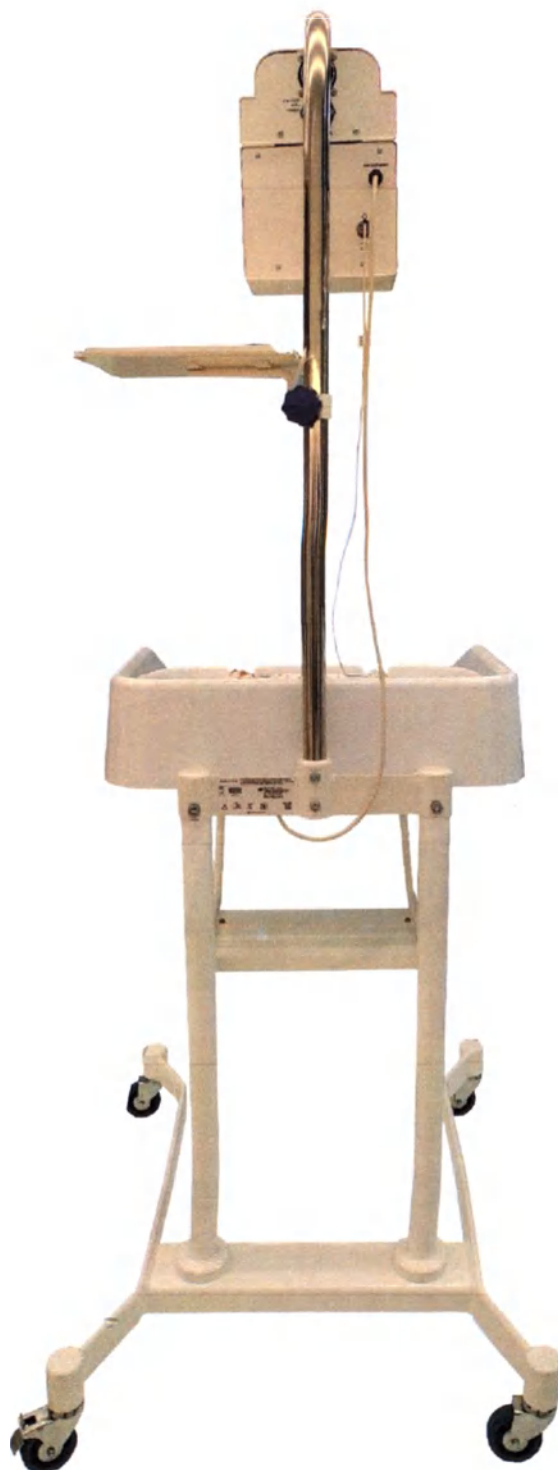

Фотографическое изображение 3 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (вид сзади)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	5 из 30



*Фотографическое изображение 4 –
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
ЮМГИ.941541.016-03 (вид слева)*

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	6 из 30



*Фотографическое изображение 5 –
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
ЮМГИ.941541.016-03 (вид справа)*

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	7 из 30



Фотографическое изображение 6 –
Подушка ЮМГИ.681879.006

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	8 из 30



Фотографическое изображение 7 –
Кроватка фототерапевтическая ЮМГИ.942819.011

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	9 из 30




Фотографическое изображение 8 –
Гамак ЮМГИ.942819.004

Комплект фотографических изображений		ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009		Дата пересмотра	18.09.2024
		Страница	10 из 30
			
Фотографическое изображение 9 – Датчик накожный ЮМГИ.685621.068			

Комплект фотографических изображений		ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009		Дата пересмотра	18.09.2024
		Страница	11 из 30
			
Фотографическое изображение 10 Кабель сетевой ЮМГИ.685631.122-01			

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	12 из 30

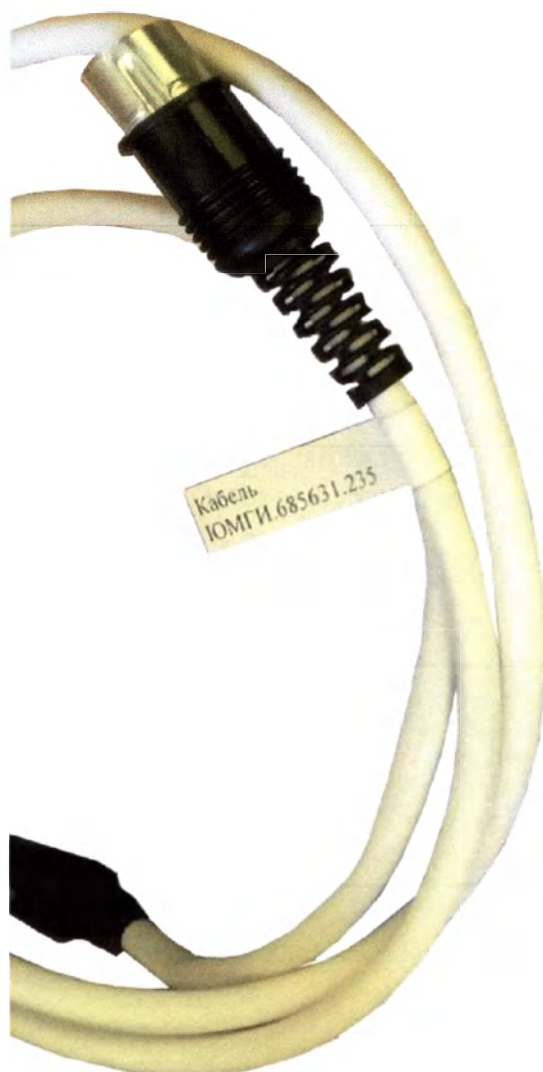

Фотографическое изображение 11 –
Кабель ЮМГИ.685631.235

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	13 из 30


**УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВА НОВОРОЖДЕННОГО
С ФУНКЦИЙ ФОТОТЕРАПИИ УОН-03Ф «АКСИОН»
ПО ТУ9444-173-07530936-2009**

Руководство по эксплуатации
ЮМГИ.941541.016-03 РЭ

Версия 05
Декабрь 2023

*Фотографическое изображение 12 –
Руководство по эксплуатации ЮМГИ.941541.016-03 РЭ*

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	14 из 30

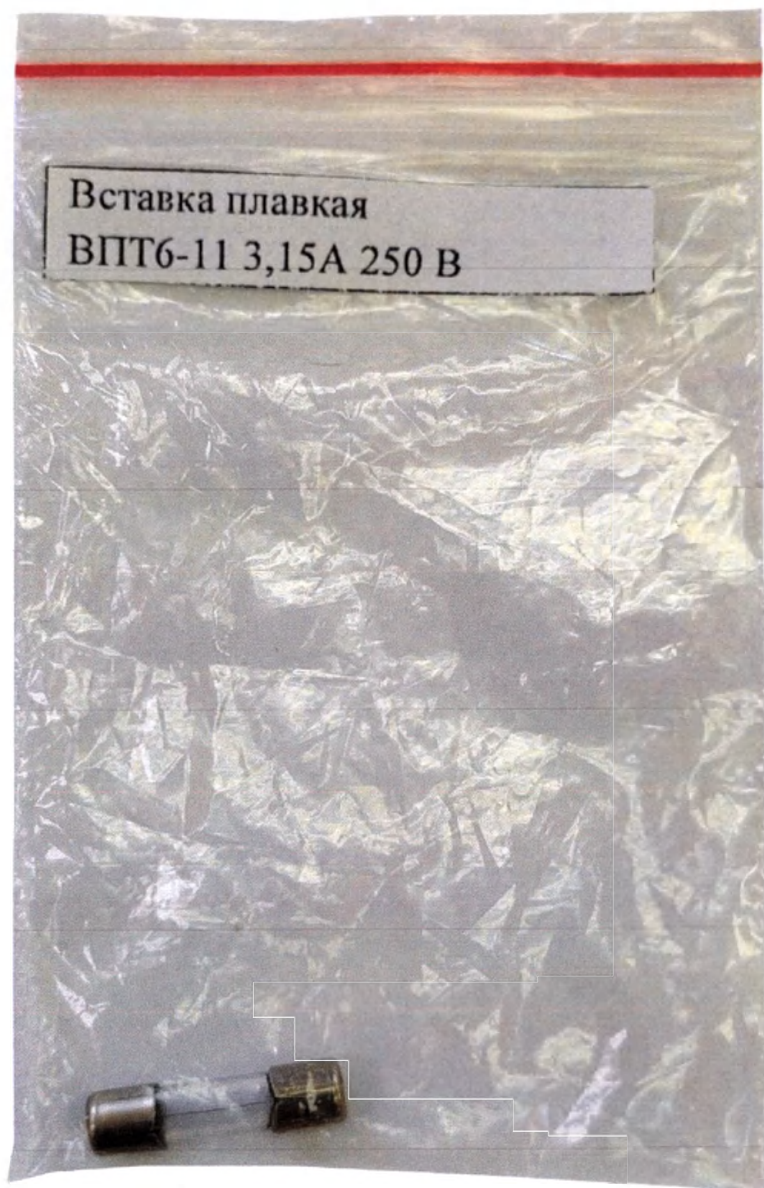


Фотографическое изображение 13 –
Вставка плавкая ВПТ6-11 3,15А 250 В

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	15 из 30



Фотографическое изображение 14 –
Вставка плавкая ВПТ6-13 5А 250 В

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	16 из 30

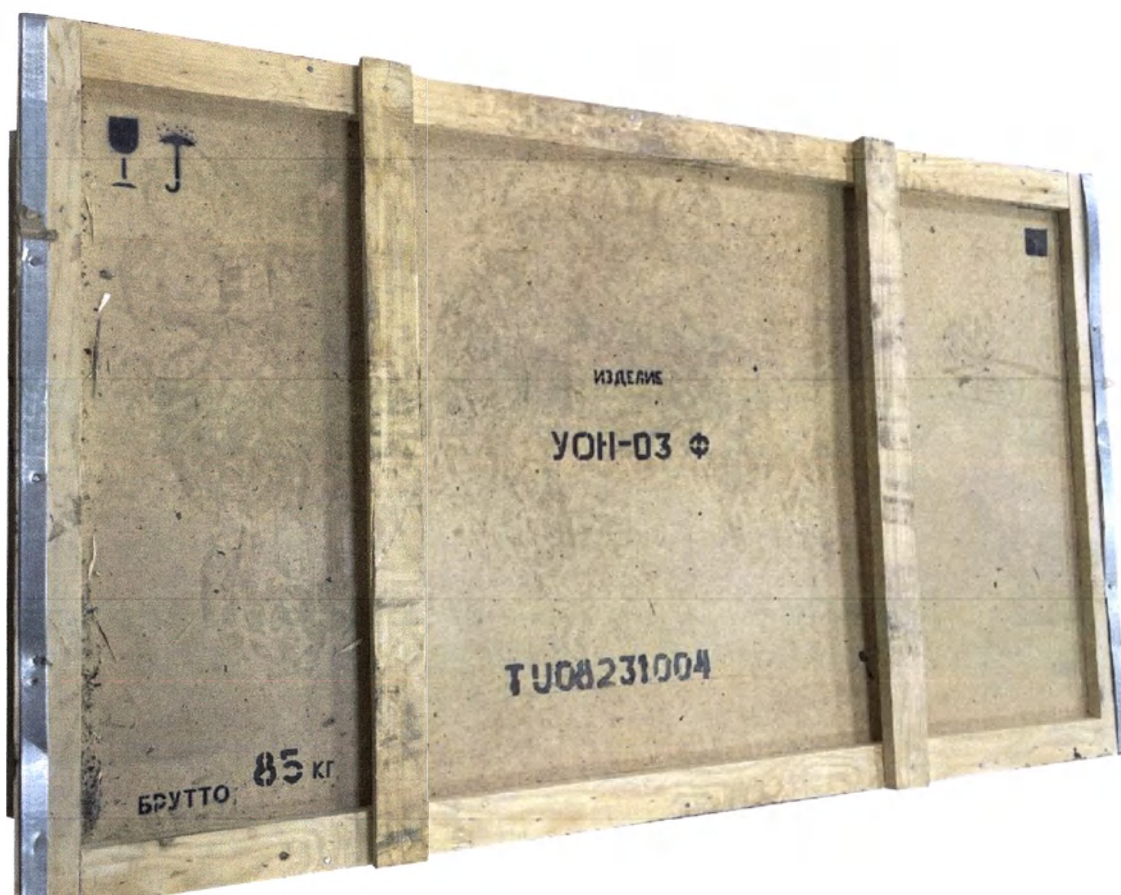

Фотографическое изображение 15 –
Транспортная упаковка (общий вид)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	17 из 30




Фотографическое изображение 16 –
Транспортная упаковка (вид изделия внутри)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	18 из 30



Фотографическое изображение 17 –
Транспортная упаковка (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	19 из 30

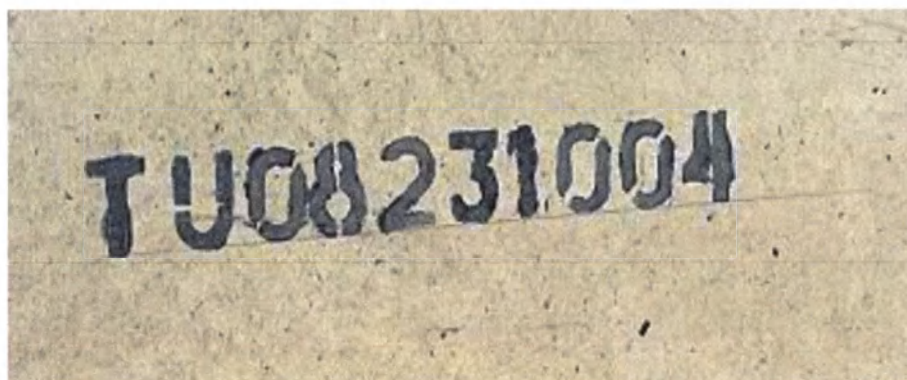

Фотографическое изображение 18 –
Транспортная упаковка (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	20 из 30




Фотографическое изображение 19
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	21 из 30




Фотографическое изображение 20 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	22 из 30

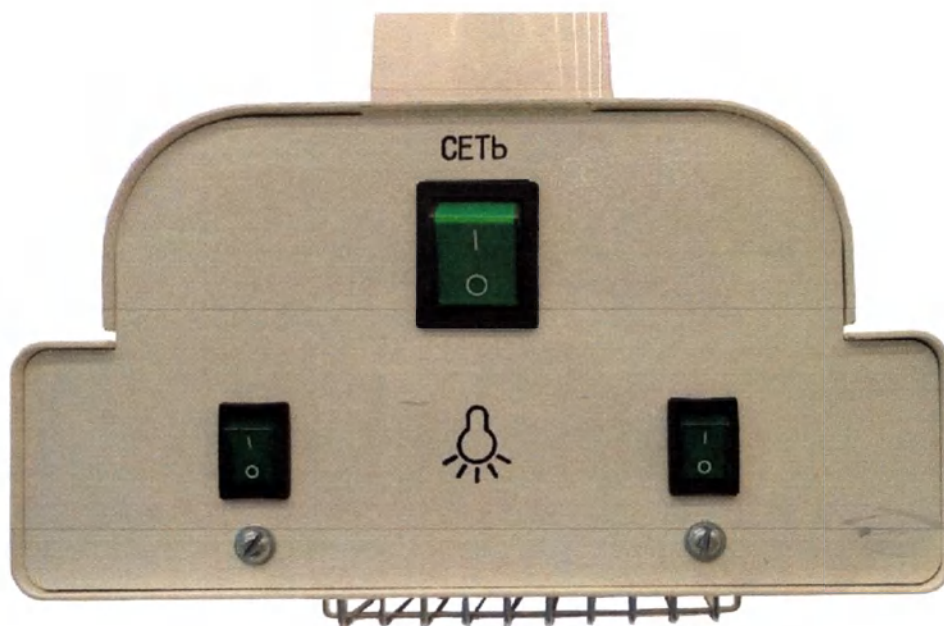

Фотографическое изображение 21 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	23 из 30

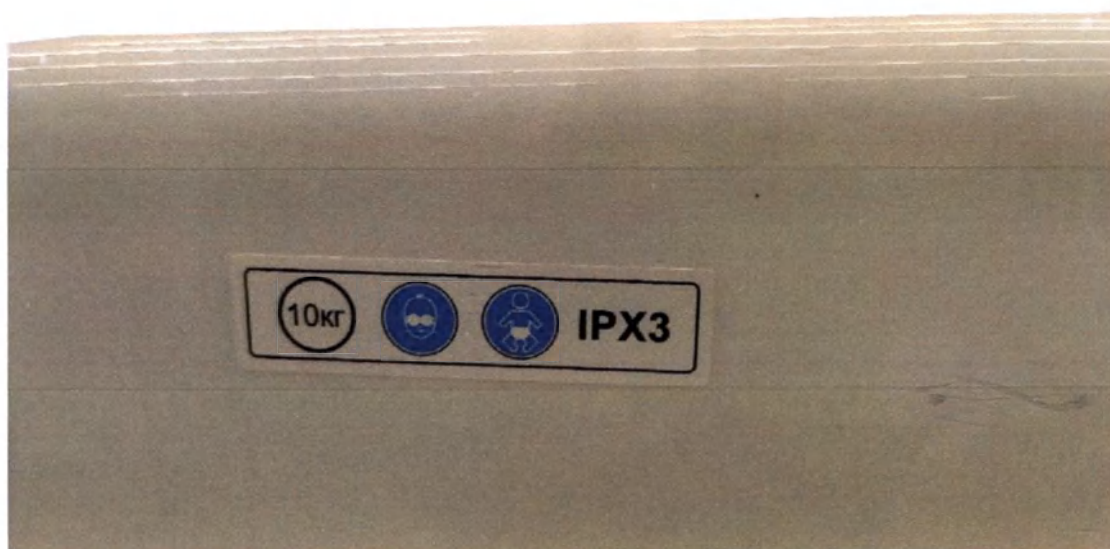

Фотографическое изображение 22 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	24 из 30



Фотографическое изображение 23 –
 Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
 ЮМГИ.941541.016-03 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	25 из 30



Фотографическое изображение 24 –
Кабель сетевой ЮМГИ.685631.122-01 (маркировка)


Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	26 из 30



Фотографическое изображение 25 –
Кабель ЮМГИ.685631.235 (маркировка)

Комплект фотографических изображений		ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009		Дата пересмотра	18.09.2024
		Страница	27 из 30
			
Фотографическое изображение 26 – Кабель ЮМГИ.685631.235 (маркировка)			

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	28 из 30

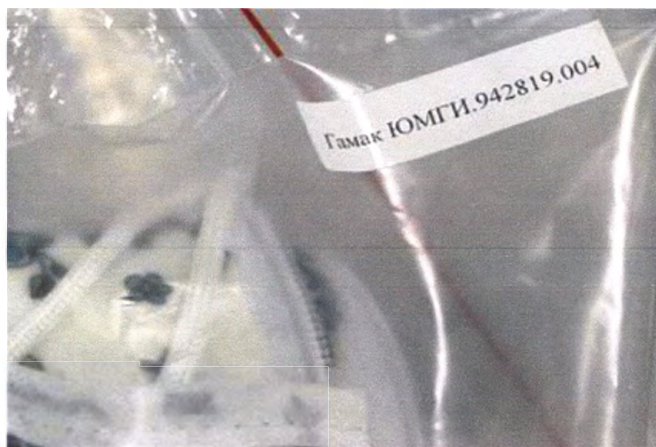

Фотографическое изображение 27 –
Гамак ЮМГИ.942819.004 (маркировка)

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	29 из 30
		
Фотографическое изображение 28 – Кроватка фототерапевтическая ЮМГИ.942819.011 (маркировка)		

Комплект фотографических изображений	ЮМГИ.941541.016-03 Д	
Устройство обогрева новорожденного с функцией фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН» по ТУ 9444-173-07530936-2009	Дата пересмотра	18.09.2024
	Страница	30 из 30



Фотографическое изображение 29 –
Подушка ЮМГИ.681879.006 (маркировка)

...модован, прош., рвано. склепено по штыю
30
Приведено ПТЕР
ВЕРИЯ ДРАВУШИИ ОБ
ДОВЕРЕННОС Ь
Подпись 33 279 ОТ 03.09.2024
Держатель подлинника К.А. ГИЖЕВ Концерн «Аксион»



МАКЕТЫ МАРКИРОВОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Устройство обогрева новорожденного с функцией
фототерапии УОН-03Ф «АКСИОН»
по ТУ 9444-173-07530936-2009**

Основная этикетка






Максимальная масса принадлежностей, располагаемых на полке с кронштейном и держателем, а также на нижней полке




Рабочая часть типа BF

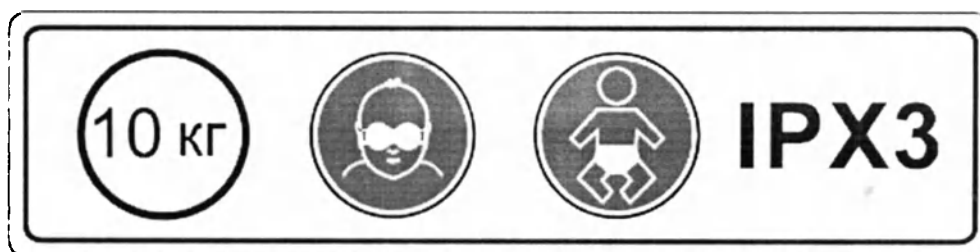

Максимальная масса пациента, необходимость защиты глаз пациента, необходимость защиты половых органов пациента, степень защиты от проникновения твердых предметов и влаги




Осторожно! Горячая поверхность

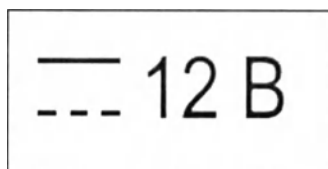

Напряжение питания постоянного тока

**~230-240В
50Гц
1000ВА**


*Напряжение питания переменного тока, частота тока и потребляемая
мощность*

 **2x5,0А**

Количество предохранителей с указанием тока срабатывания

Фототерапия

Обозначение разъема для подключения блока фототерапии



Обозначение разъема для подключения датчика накожного

СЕТЬ

Обозначение кнопки включения и выключения питания



Обозначение кнопки включения и выключения освещения

2. Макет маркировки на Подушке ЮМГИ.681879.006

Подушка
ЮМГИ.681879.006

3. Макет маркировки на Кроватке фототерапевтической
ЮМГИ.942819.011

Кроватка фототерапевтическая
ЮМГИ.942819.011

4. Макет маркировки на Гамаке ЮМГИ.942819.004

Гамак
ЮМГИ.942819.004

7. Макет маркировки на Датчике накожном ЮМГИ.685621.068

Датчик накожный
ЮМГИ.685621.068

8. Макет маркировки на Кабеле сетевом ЮМГИ.685631.122-01

Кабель сетевой
ЮМГИ.685631.122-01

9. Макет маркировки на Кабеле ЮМГИ.685631.235

Кабель
ЮМГИ.685631.235


10. Макет маркировки на Вставке плавкой ВПТ6-11 3,15 А 250 В

Вставка плавкая
ВПТ6-11 3,15 А 250 В

11. Макет маркировки на Вставке Плавкой ВПТ6-13 5 А 250 В

Вставка плавкая
ВПТ6-13 5 А 250 В - 2 шт.


12. Макеты маркировки на Транспортной упаковке

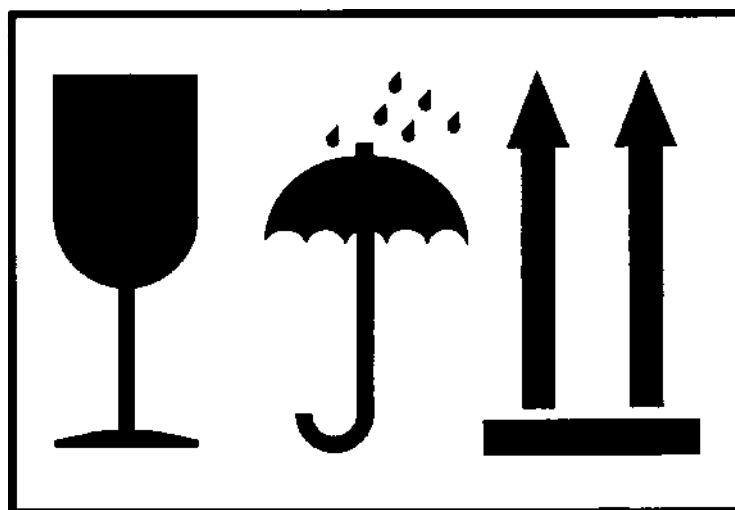

Манипуляционные знаки на боковой стороне транспортной упаковки



Манипуляционные знаки на верхней стороне транспортной упаковки

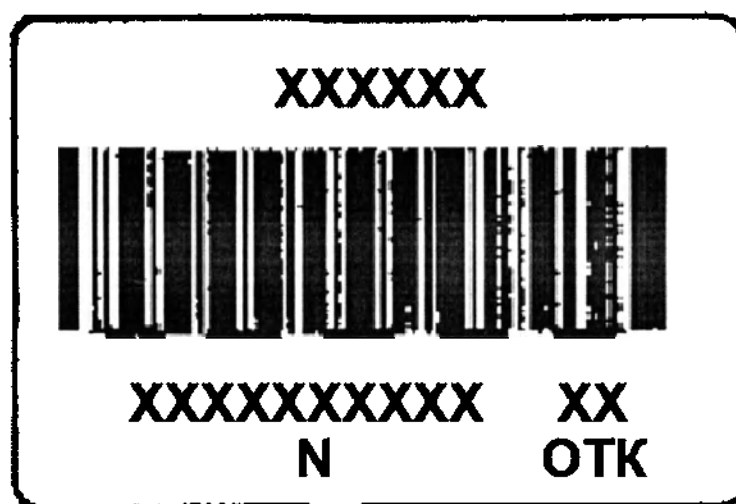

Штрих-код с серийным номером и номером заказа

БРУТТО: XX кг

Вес брутто в кг

**ИЗДЕЛИЕ
УОН-03Ф**

Сокращенное наименование изделия

XXXXXXXXXXXX

Серийный номер изделия

Всего пронумеровано 8 прог

Восемь лет

ВЕРНО
И. И. ДРАВИШНИКОВ

Подпись: [подпись] 05.20.24

Держатель: [подпись] концерн «Аксион»

