

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:  
**Стол для осмотра и терапевтических процедур Capre EX, в вариантах исполнения**

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойер Медикал»

  
Самсонов В.Ю.



ООО Лойер Медикал Представительство Lojer Oy в России и странах СНГ  
121357, Россия, Москва, ул. Верейская д.29 строение 134БЦ «Верейская Плаза III» Тел. +7 (495) 269 06 95  
[russia@lojer.com](mailto:russia@lojer.com) | [www.lojer.com](http://www.lojer.com)




**1. Стол для осмотра и терапевтических процедур Carpe EX1, в составе:**



**1.1. Секция ложа цельная**




**1.2. Держатель рулона бумаги**

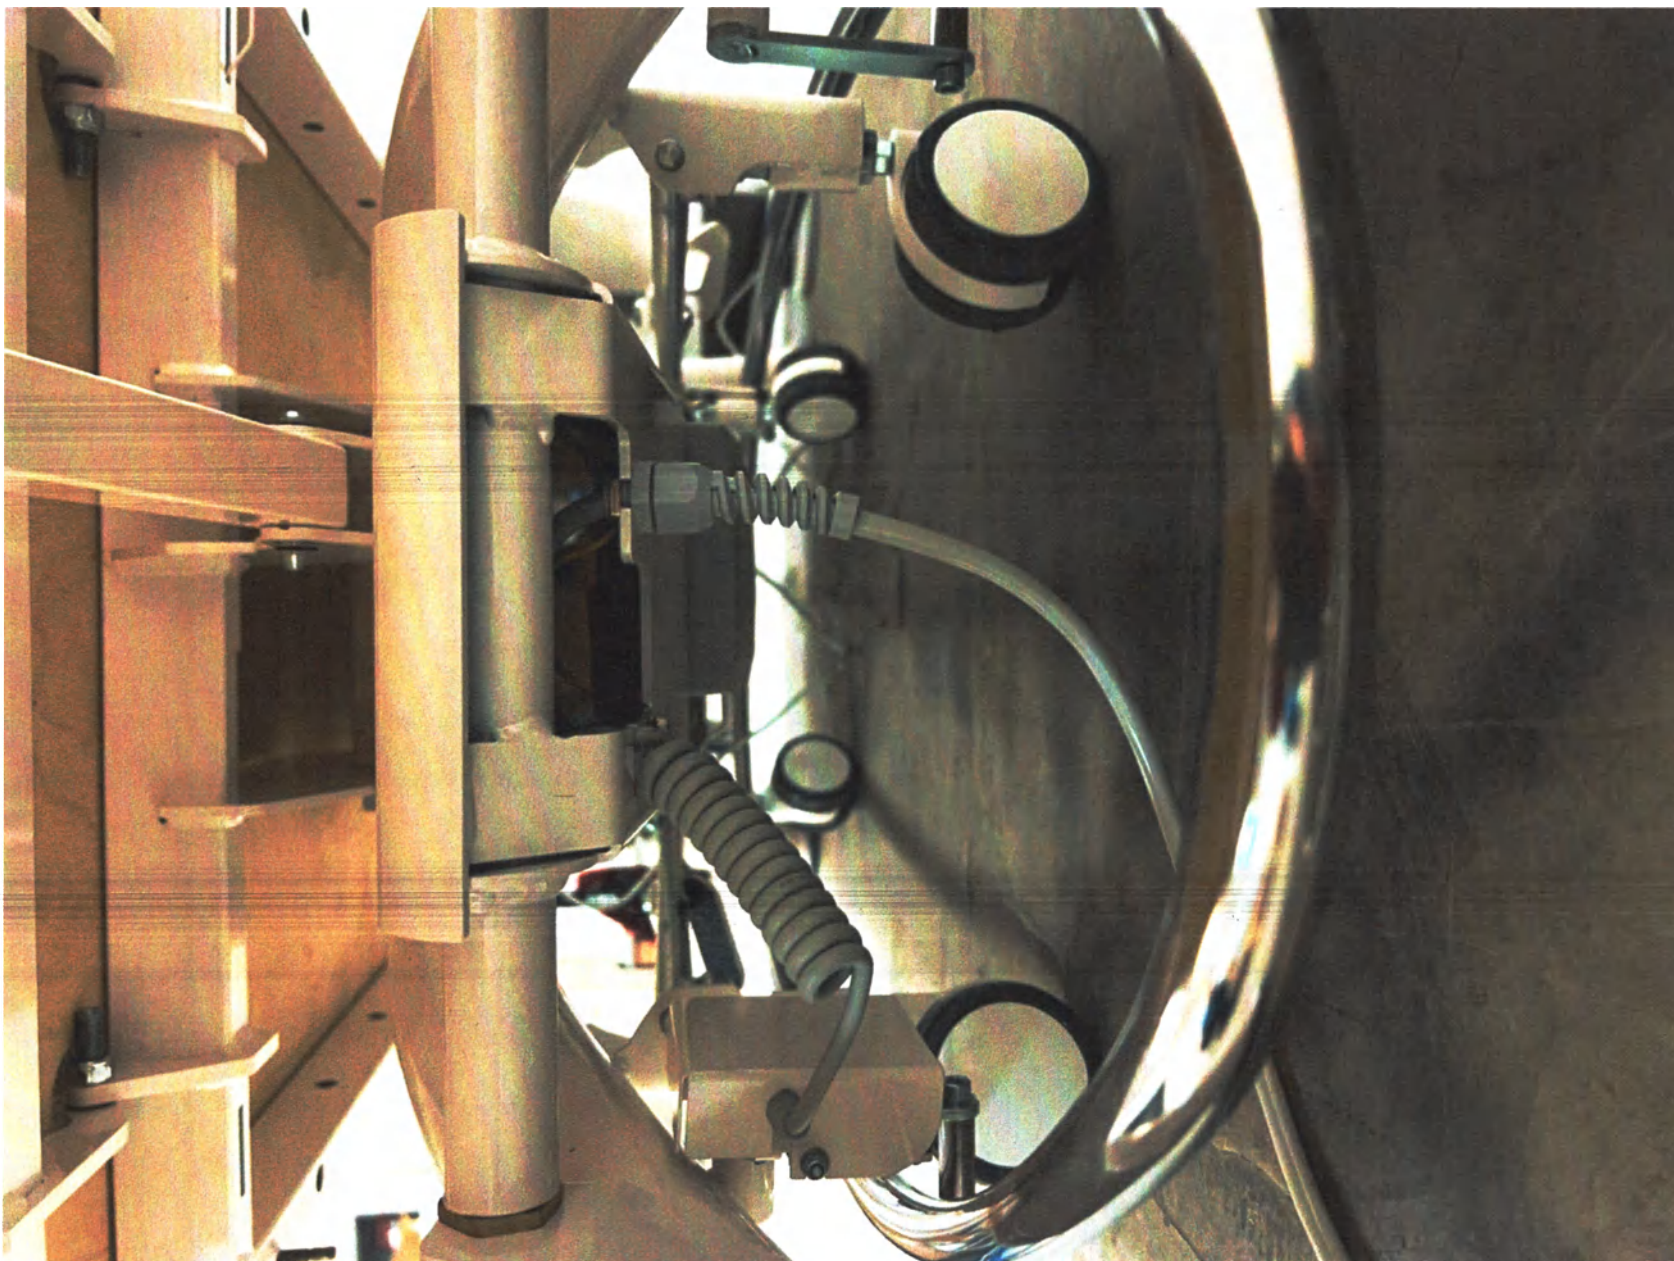


1.3. Колеса с центральной блокировкой




1.4. Педаль-рама

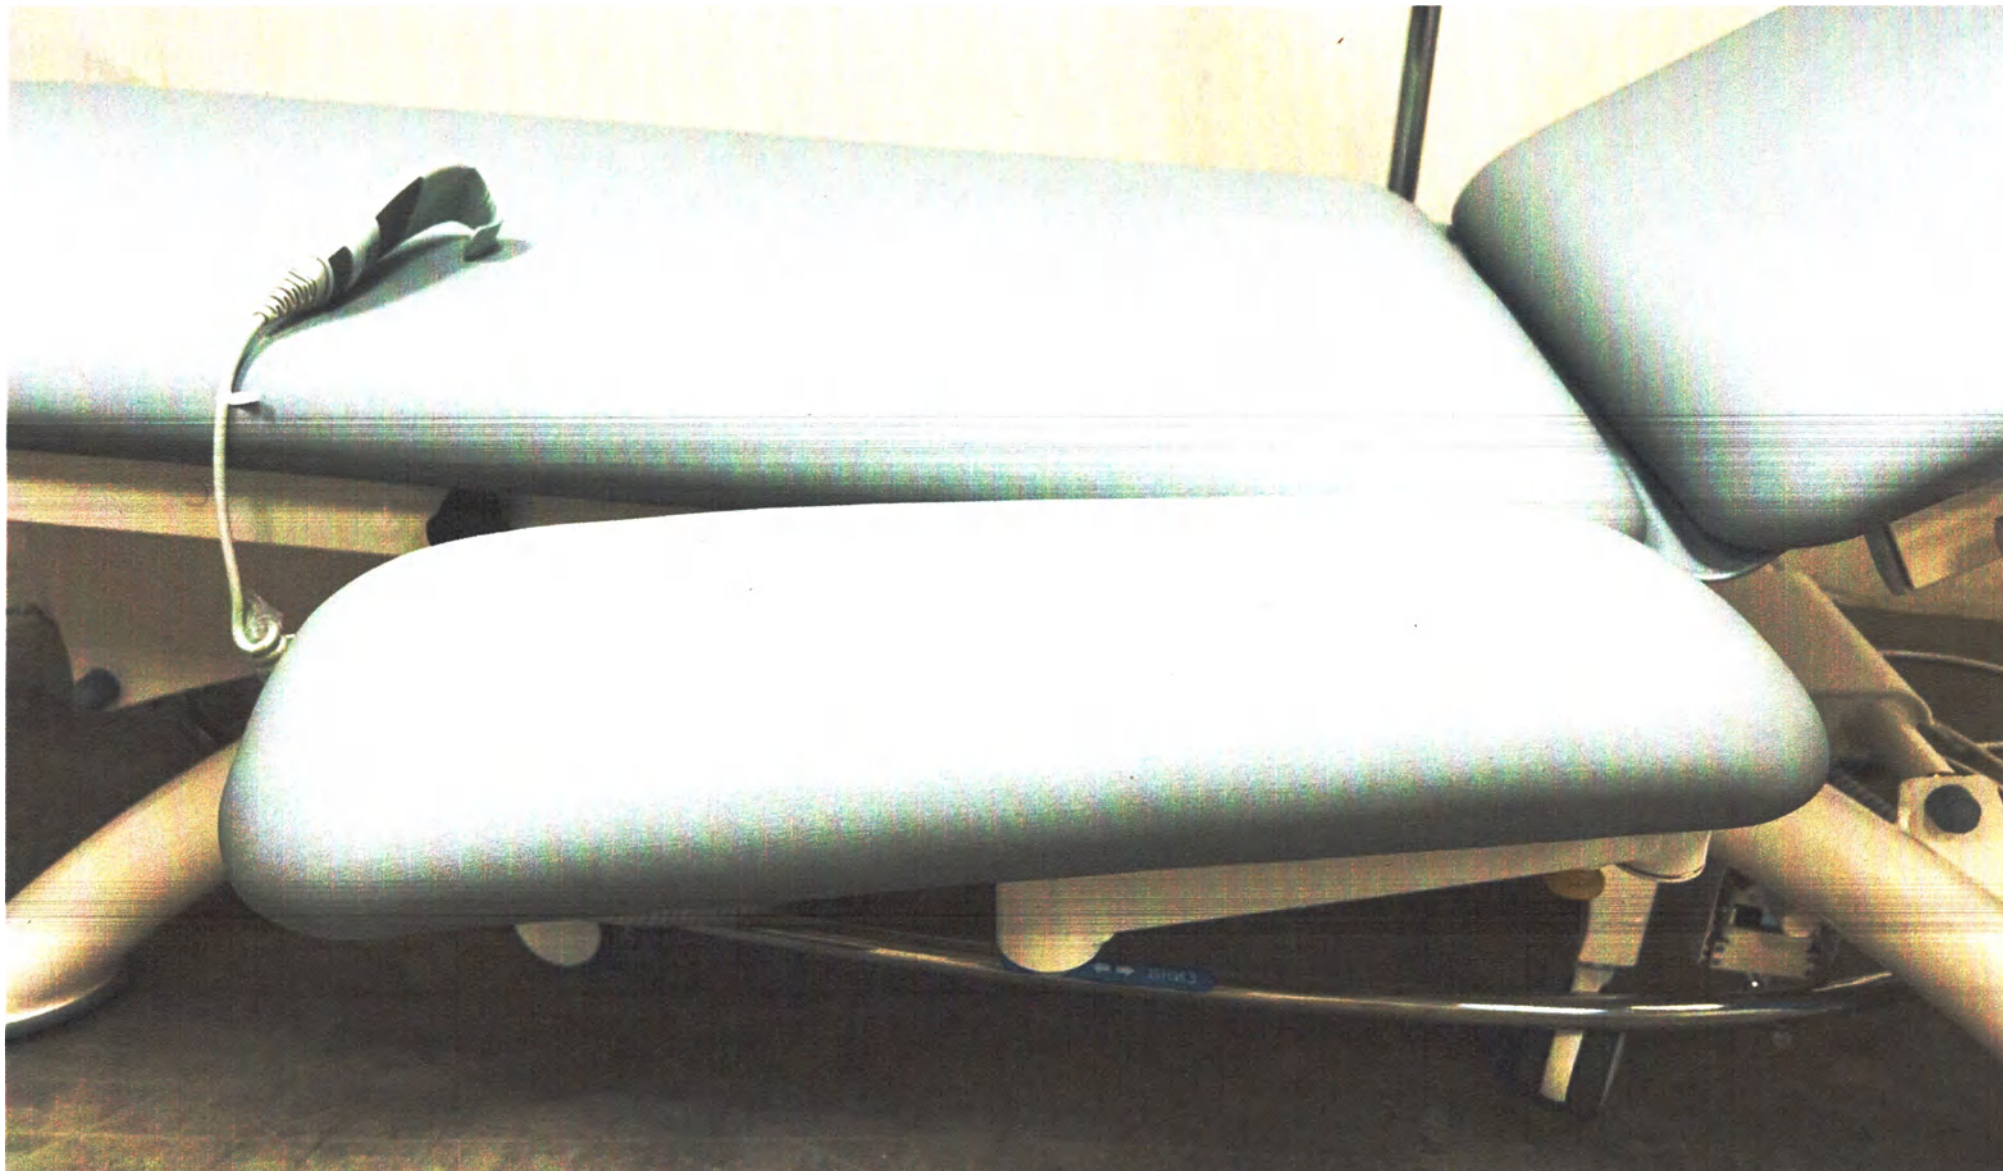


**1.5. Подлокотник**

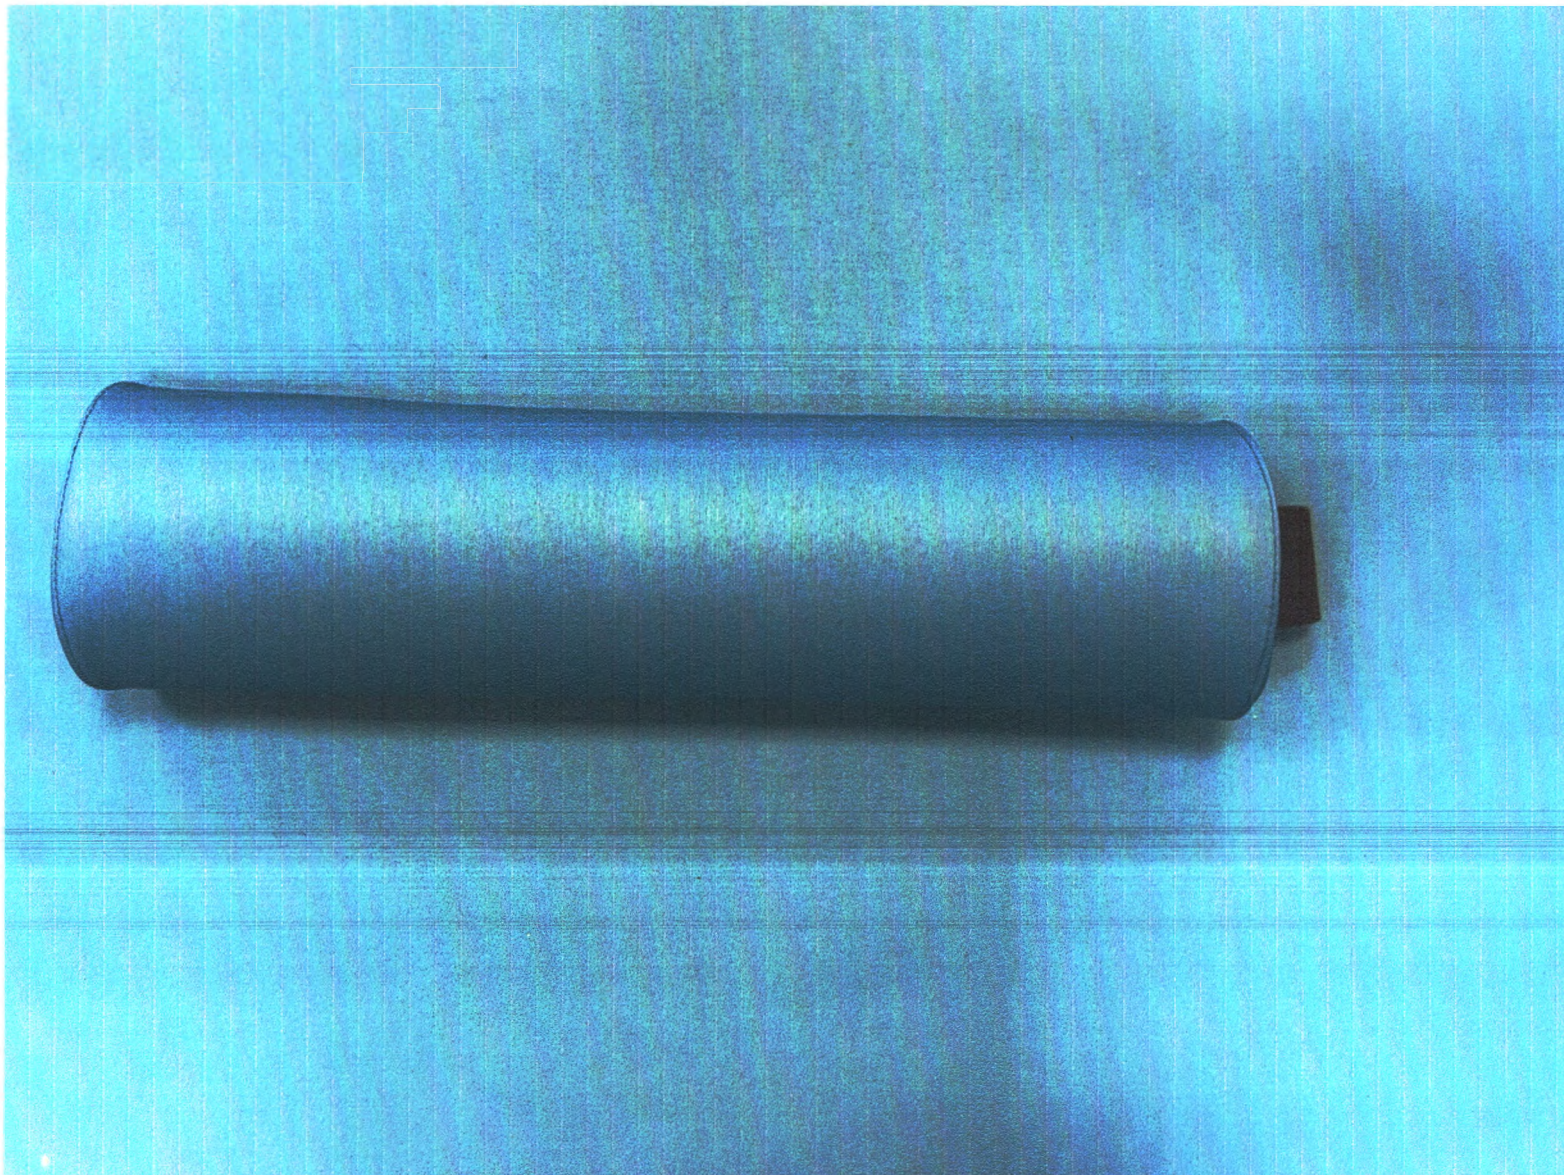

**1.6. Подушка**

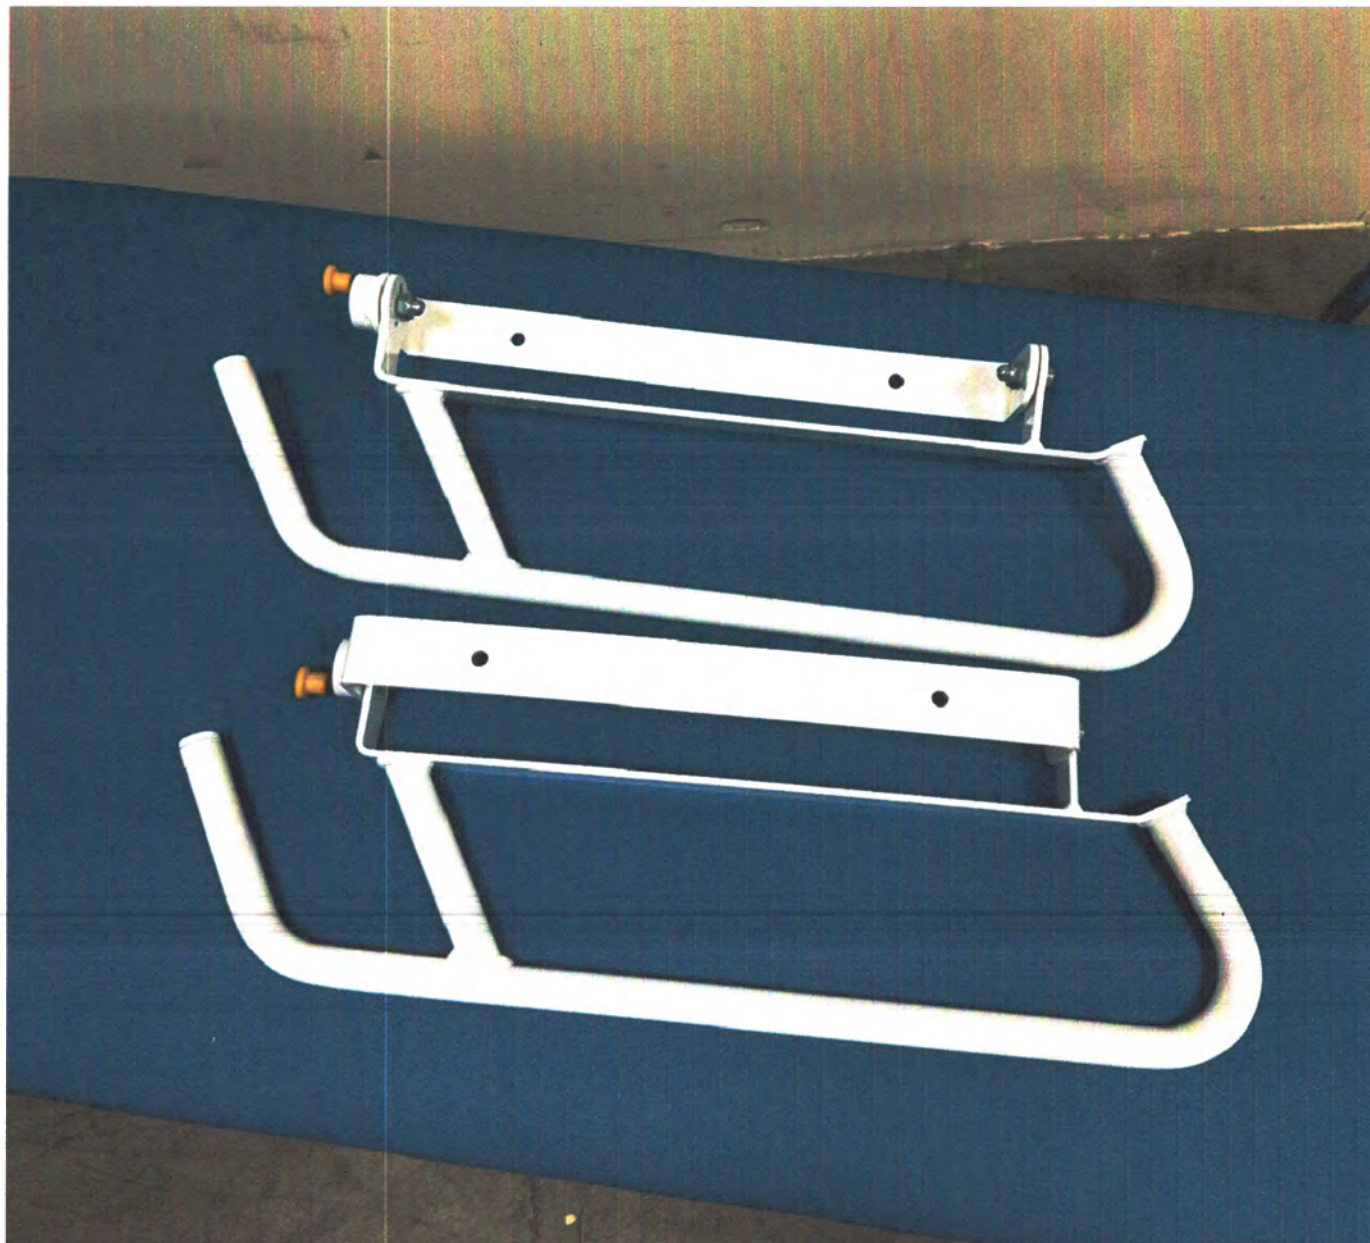


**1.7. Боковое ограждение, в составе:**

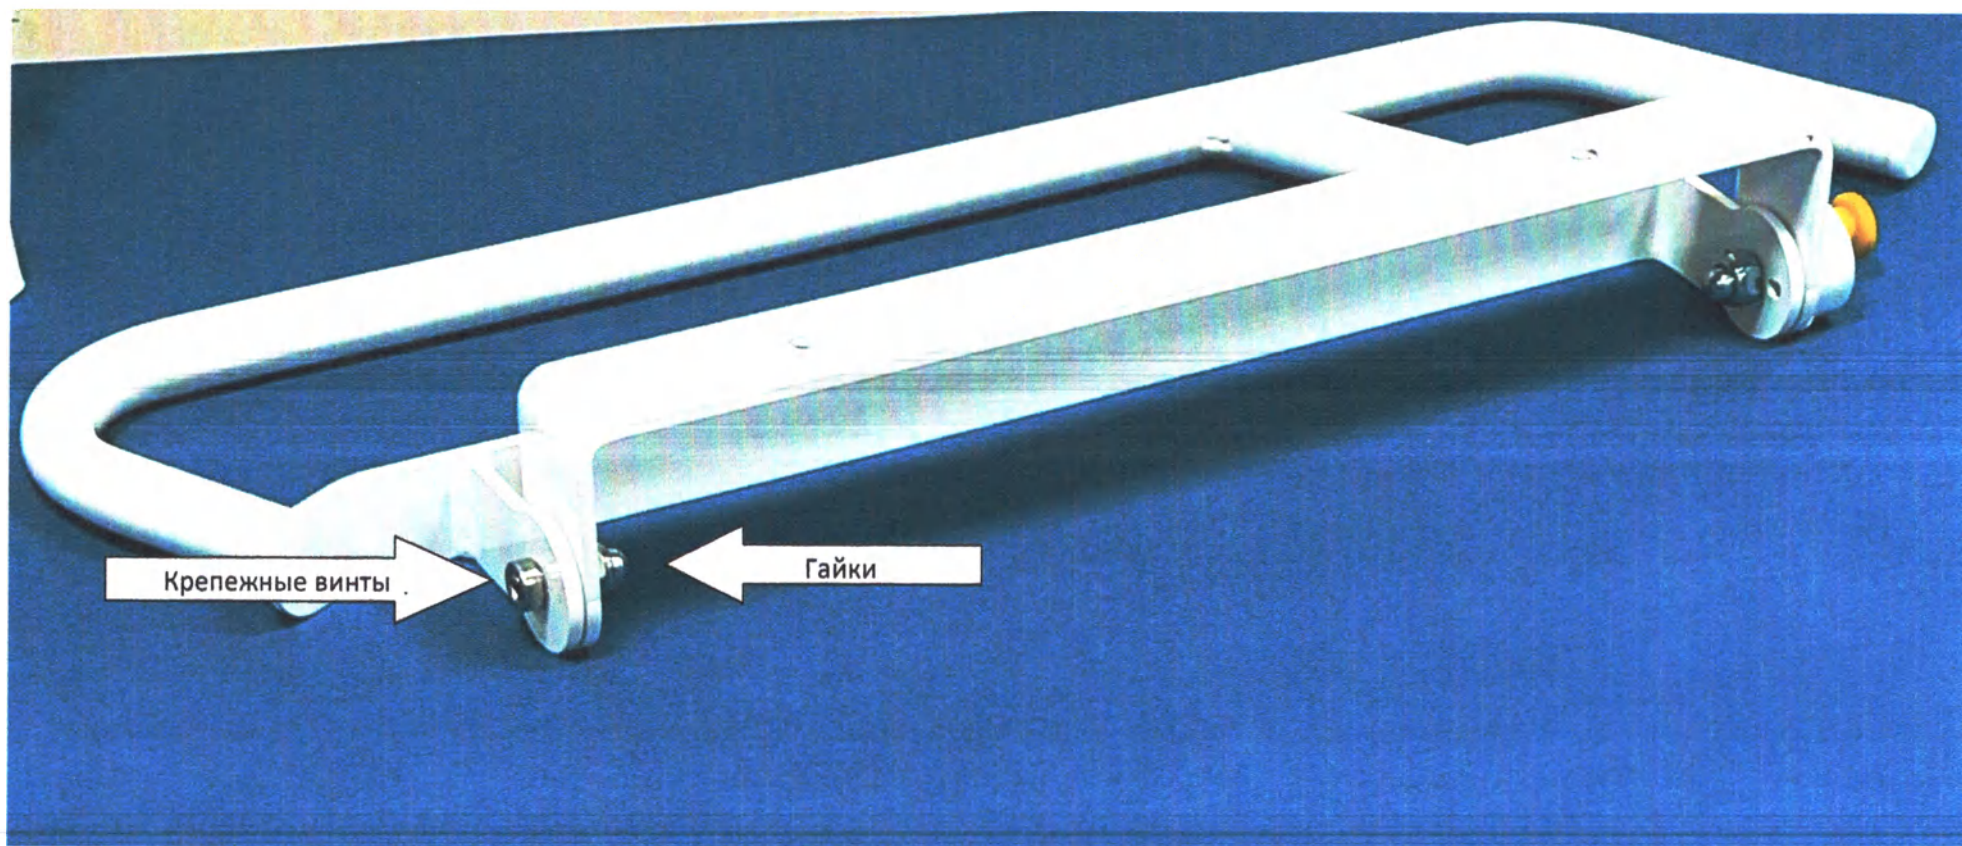


- Крепежные винты  
- Гайки




**1.8. Крышки, закрывающие отверстия для крепежных винтов для установки боковых ограждений  
(предустановленные на столе)**

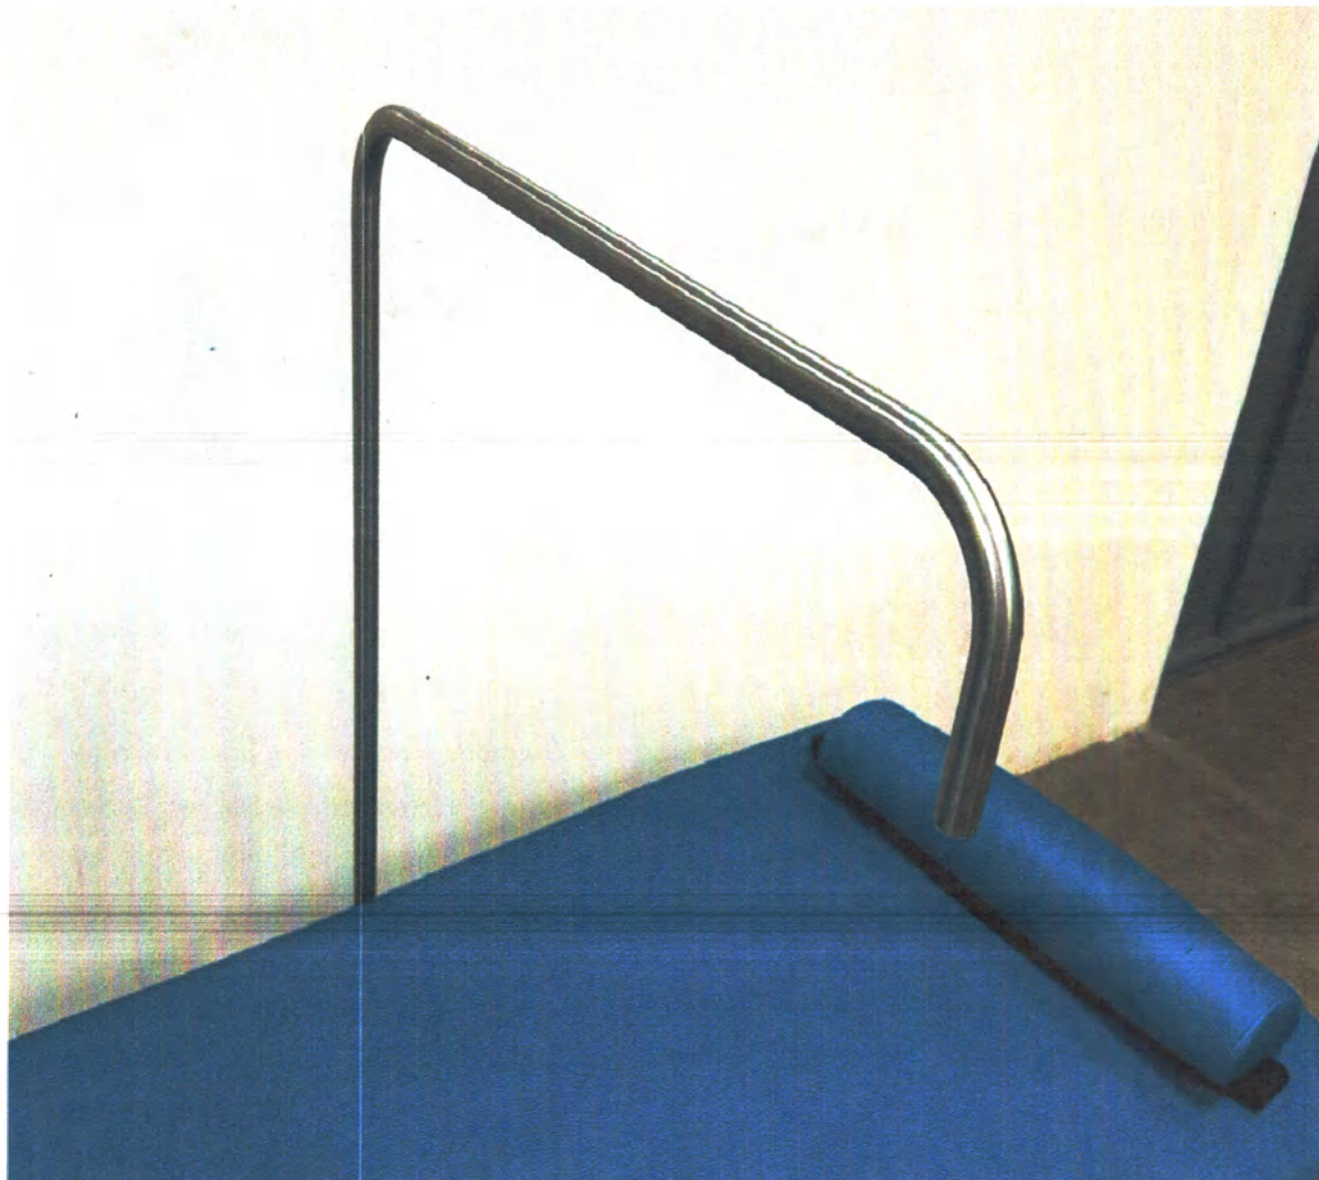


**1.9. Анестезиологическая дуга**

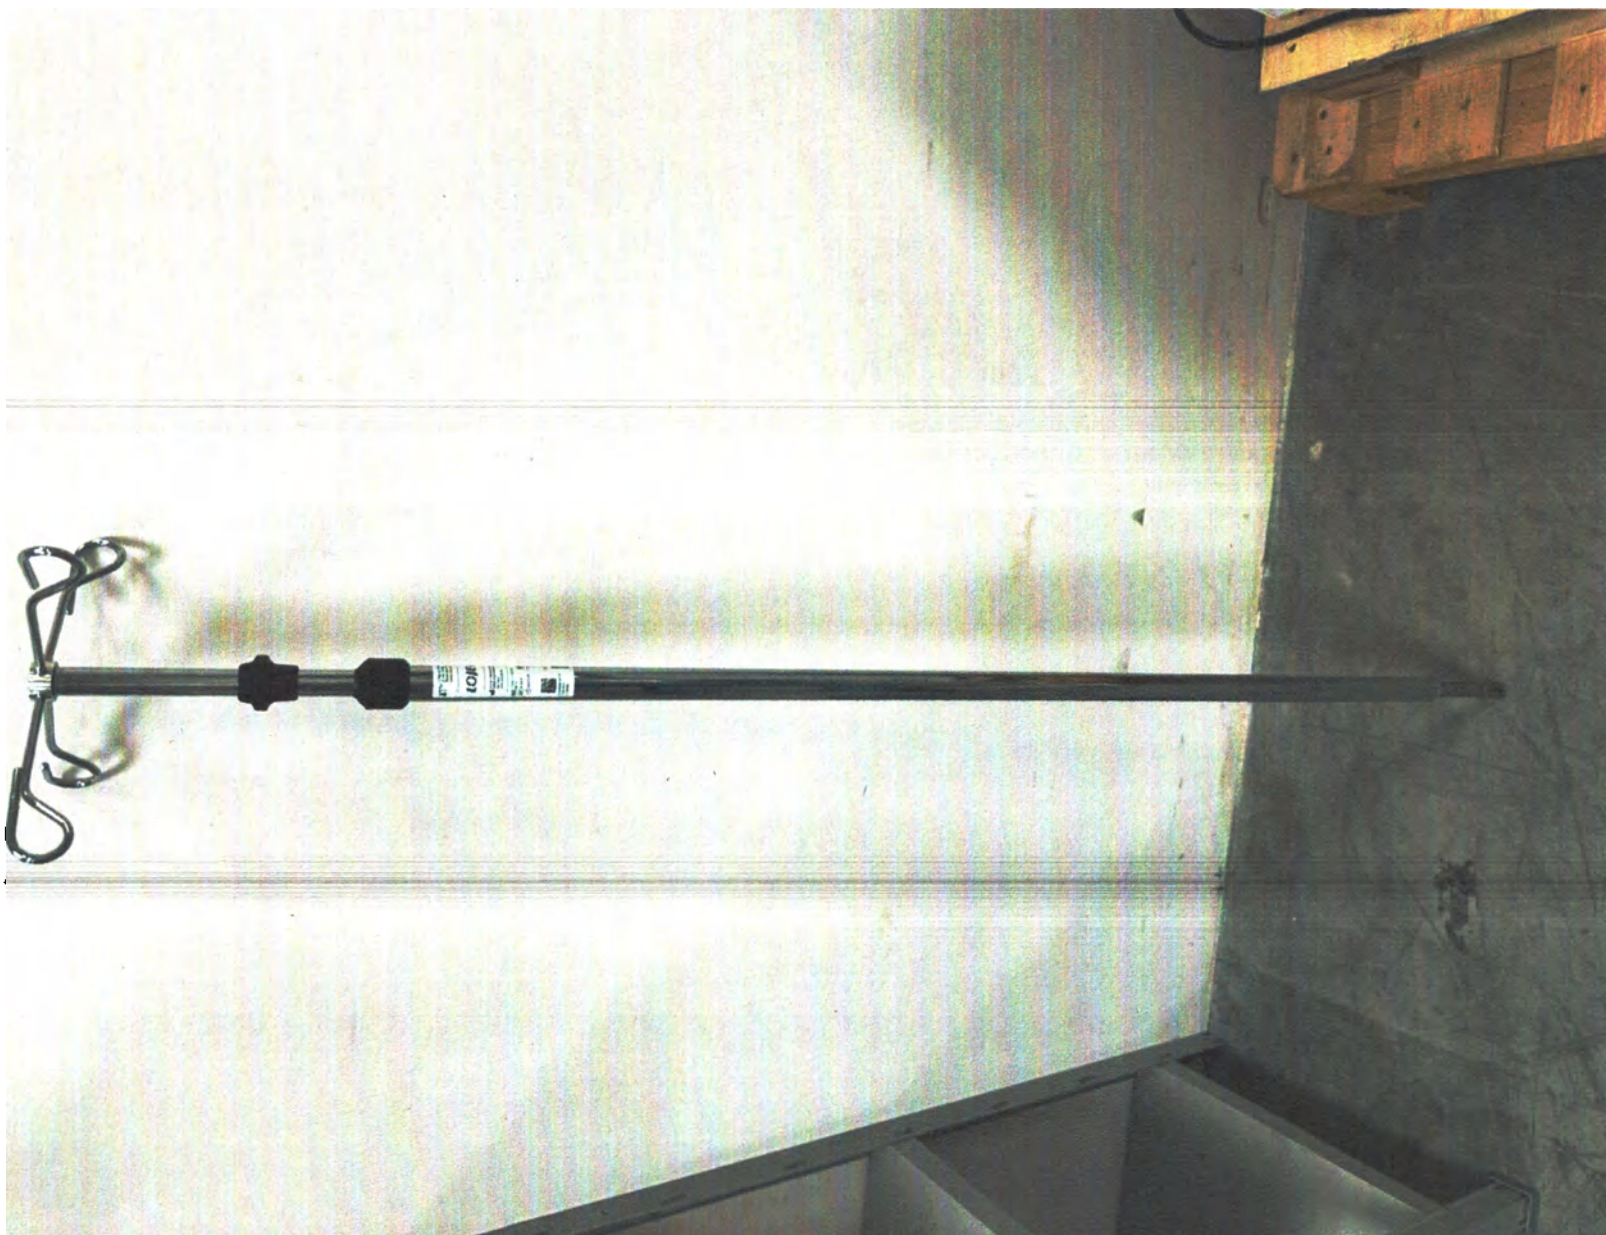


**1.10. Штатив для внутривенных вливаний прямой**

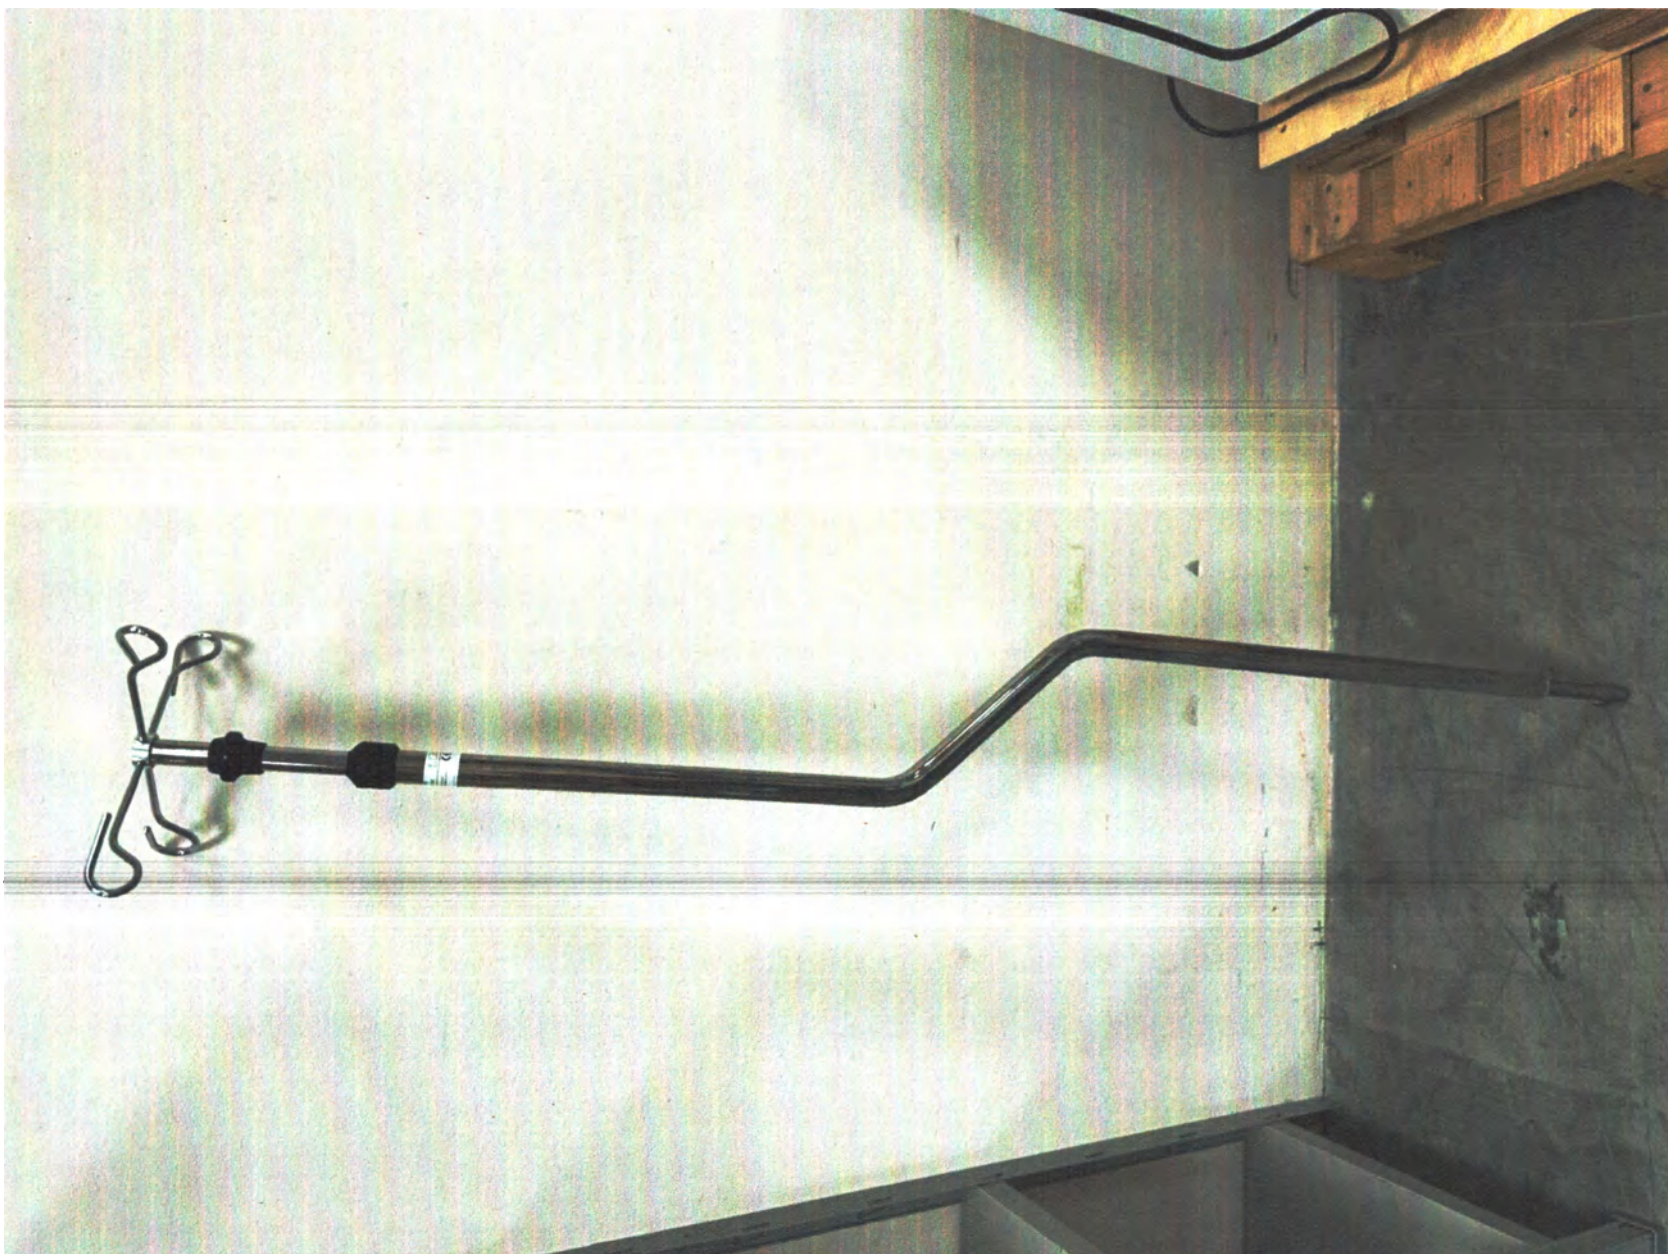


**1.11. Штатив для внутривенных вливаний изогнутый**

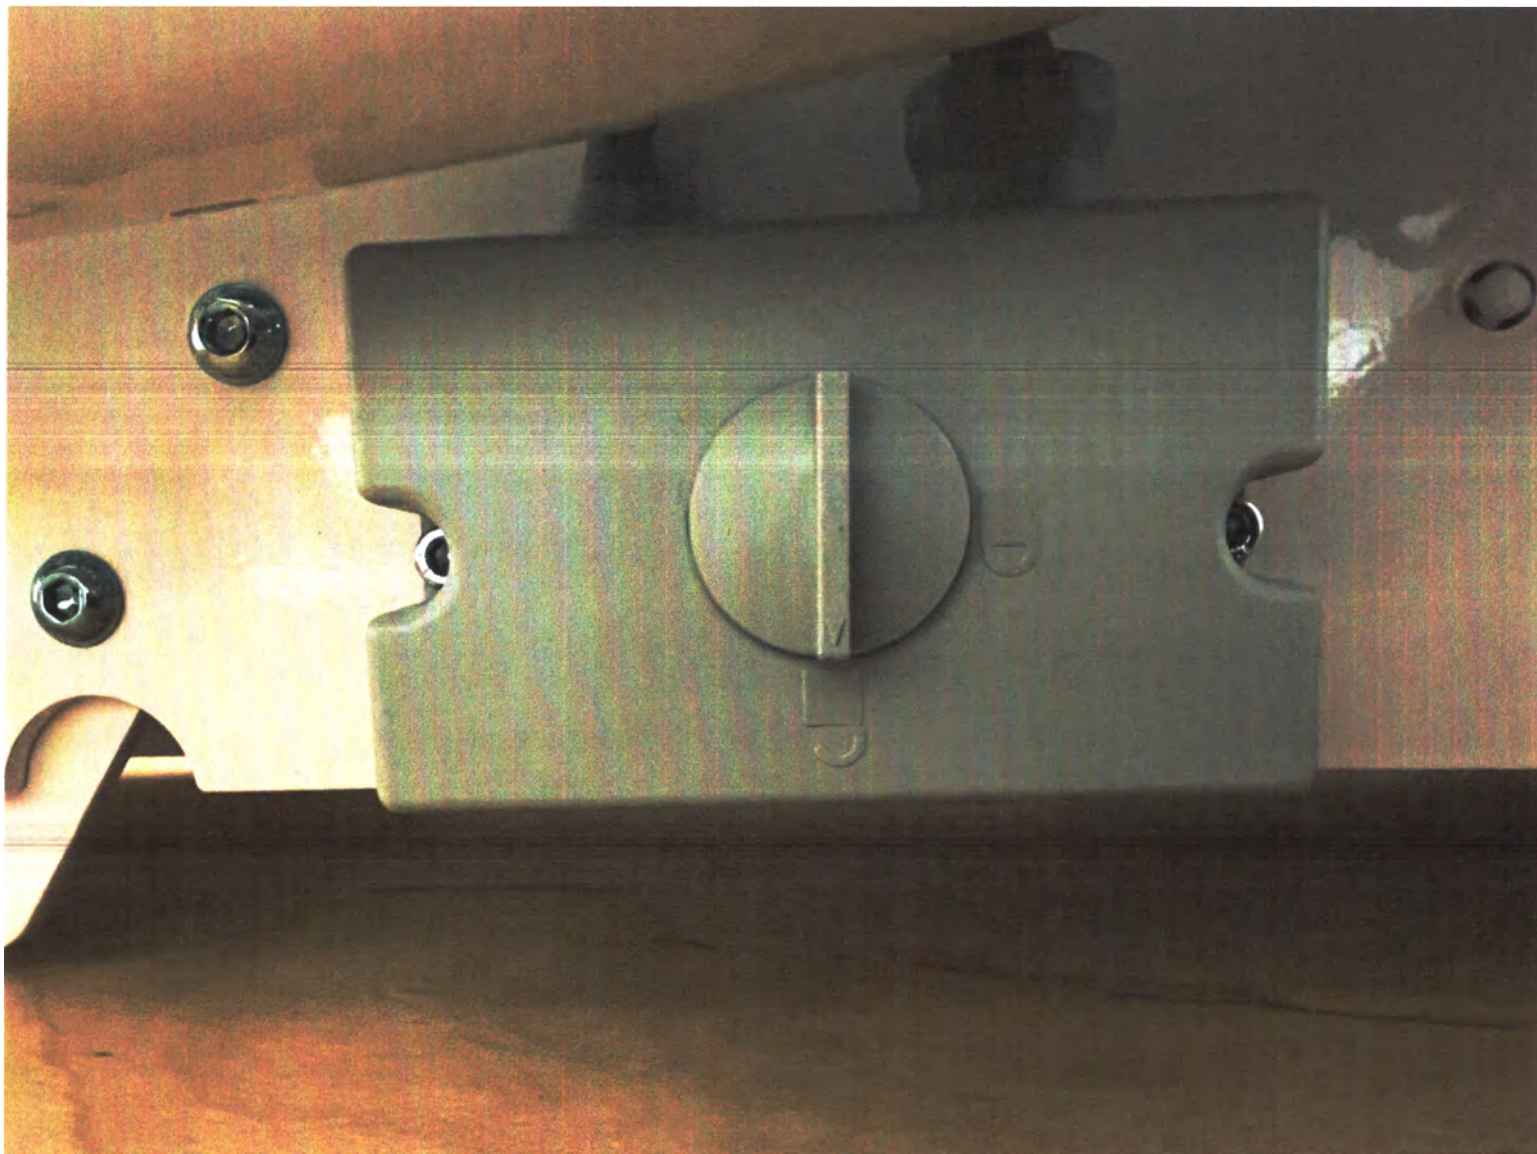


**1.12. Защитный выключатель**

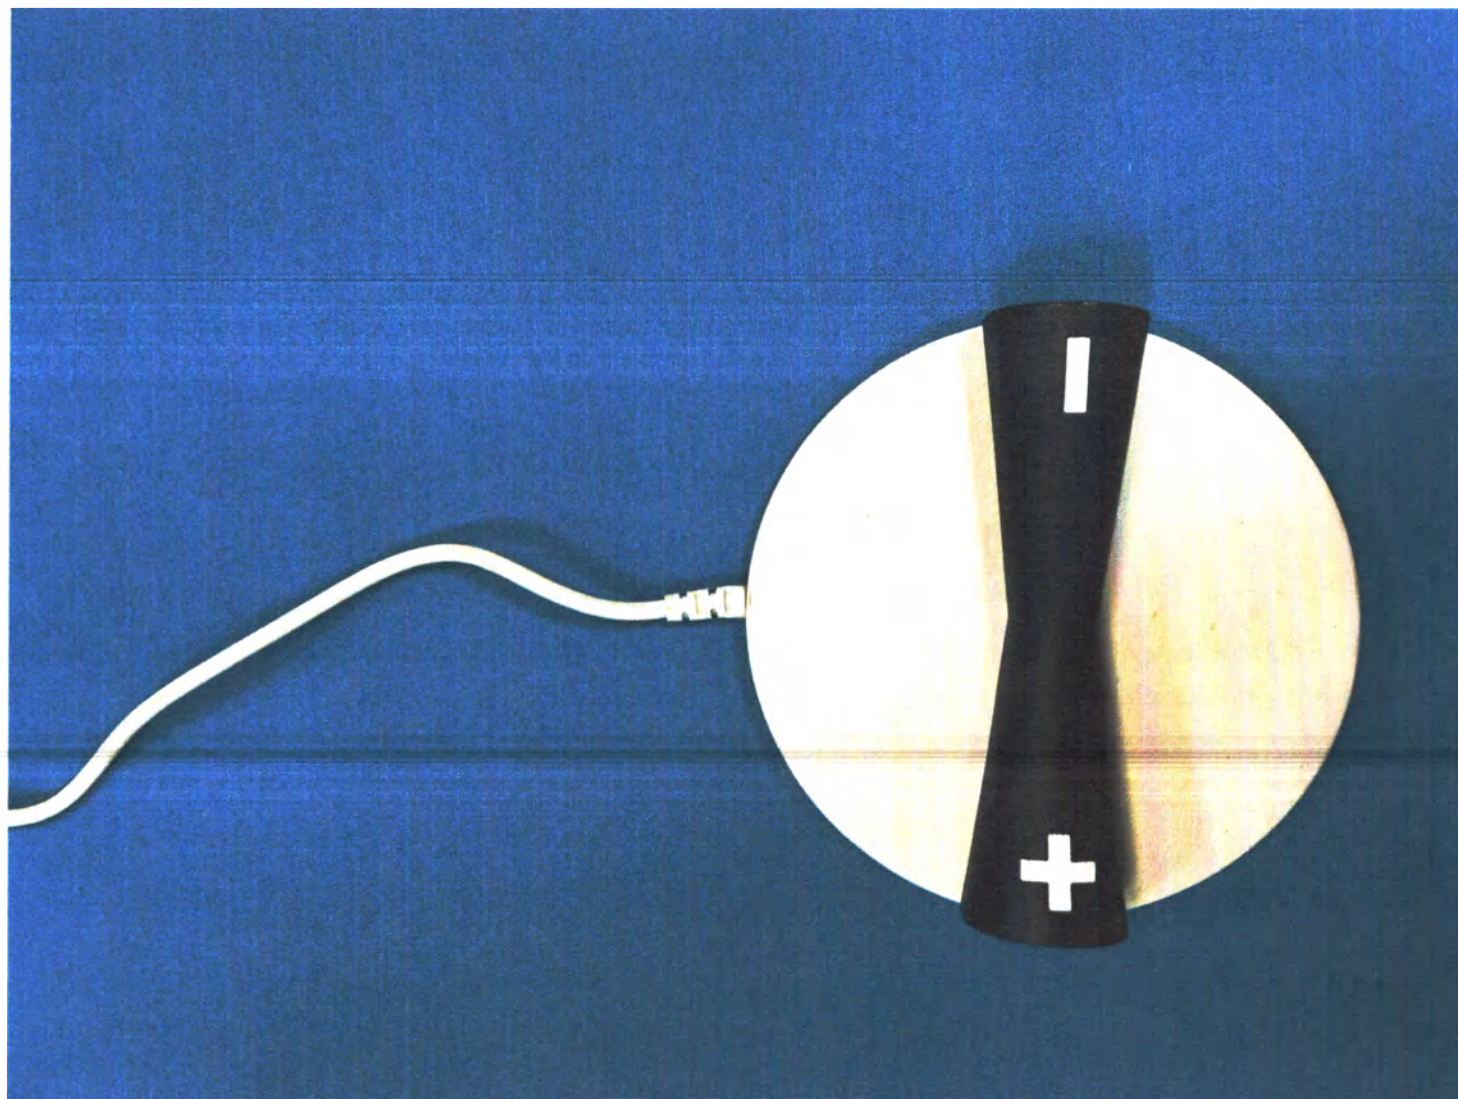


**1.13. Пульт ножного управления**

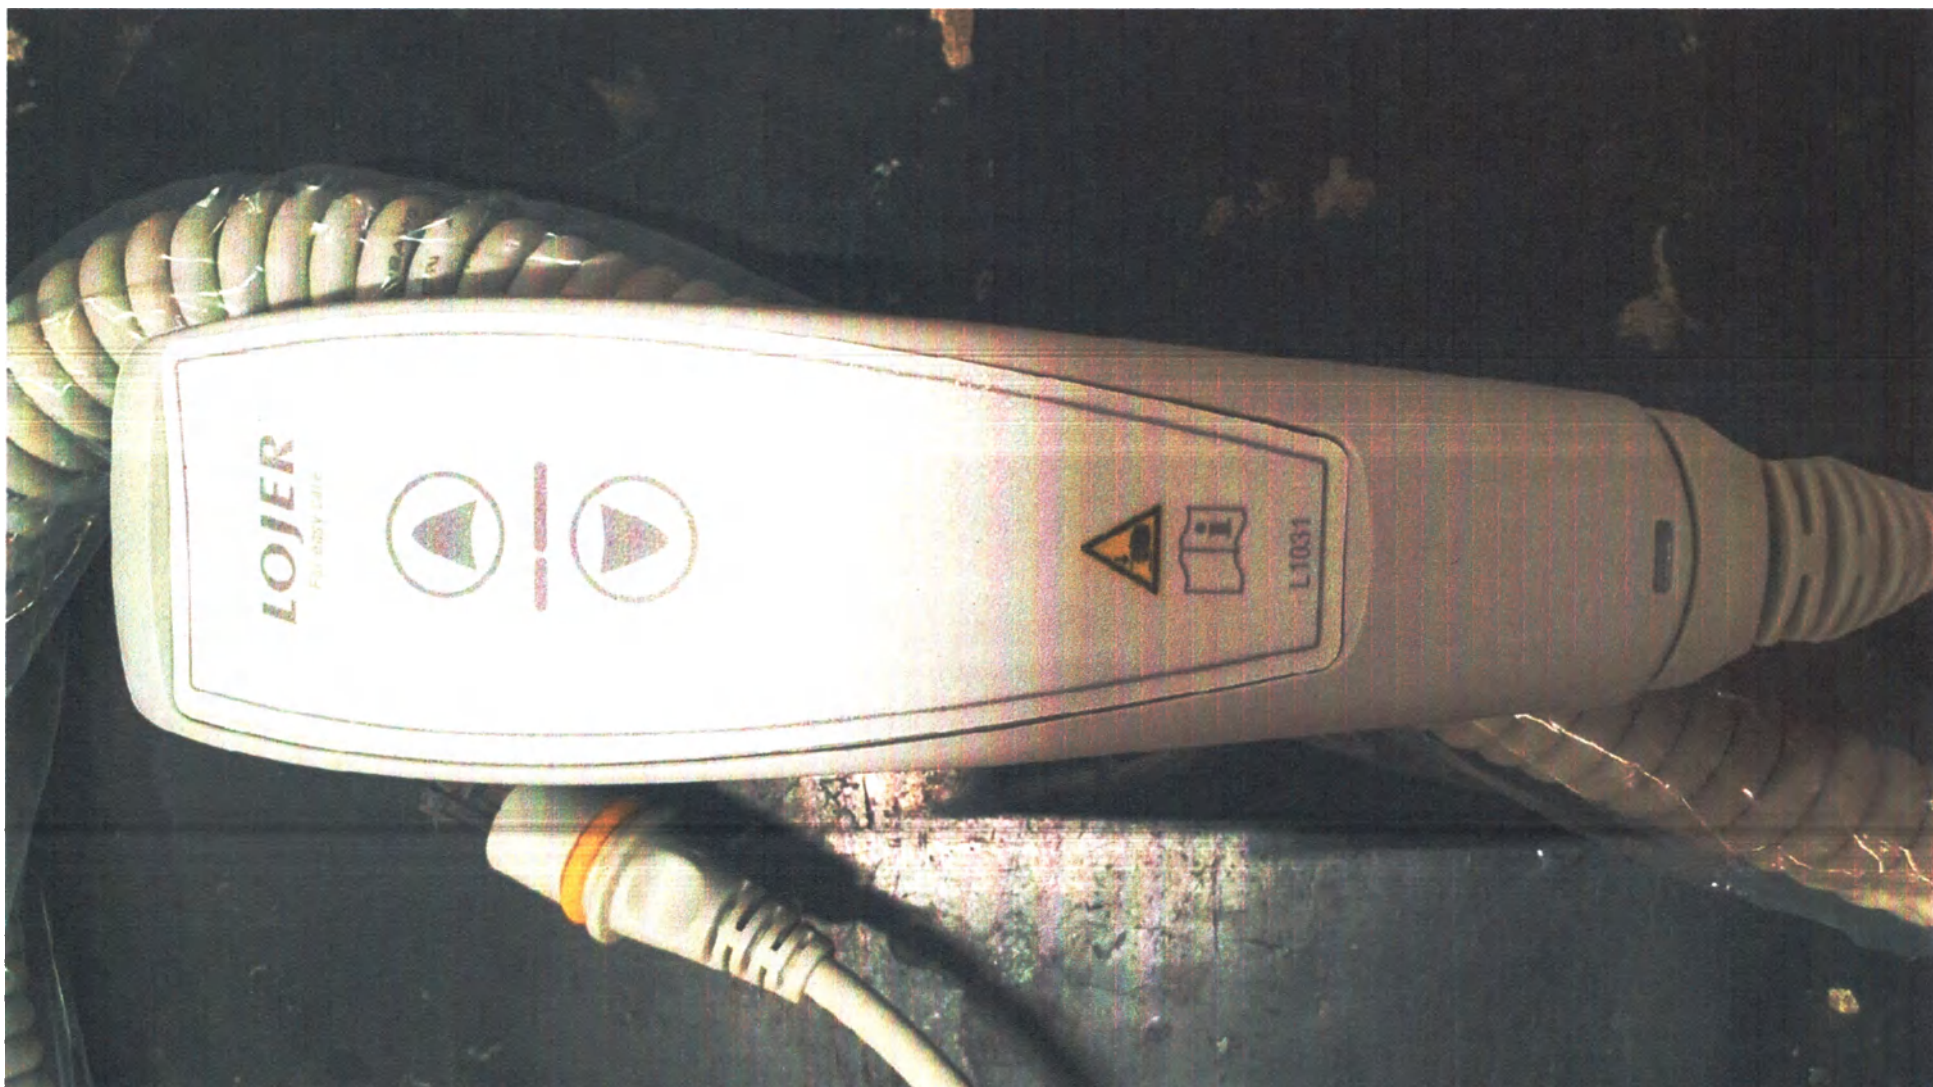


**1.14. Пульт ручного управления**

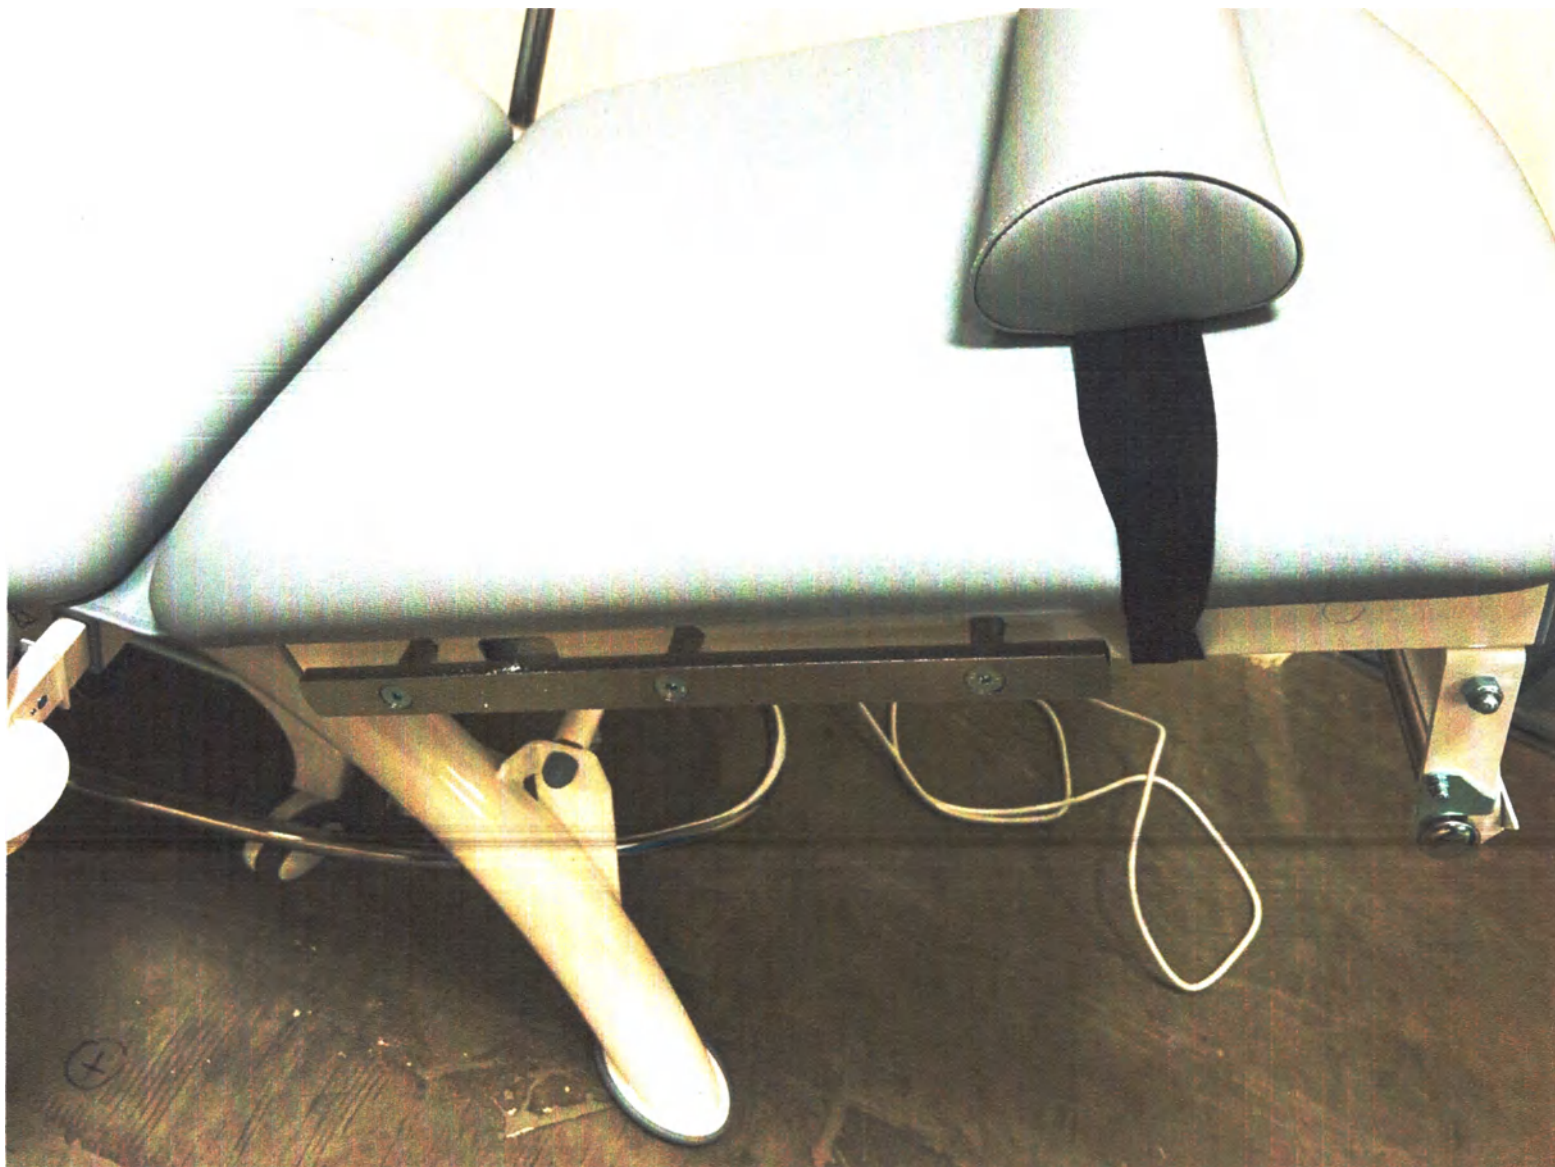

**1.15. Рельс для установки дополнительных приспособлений**

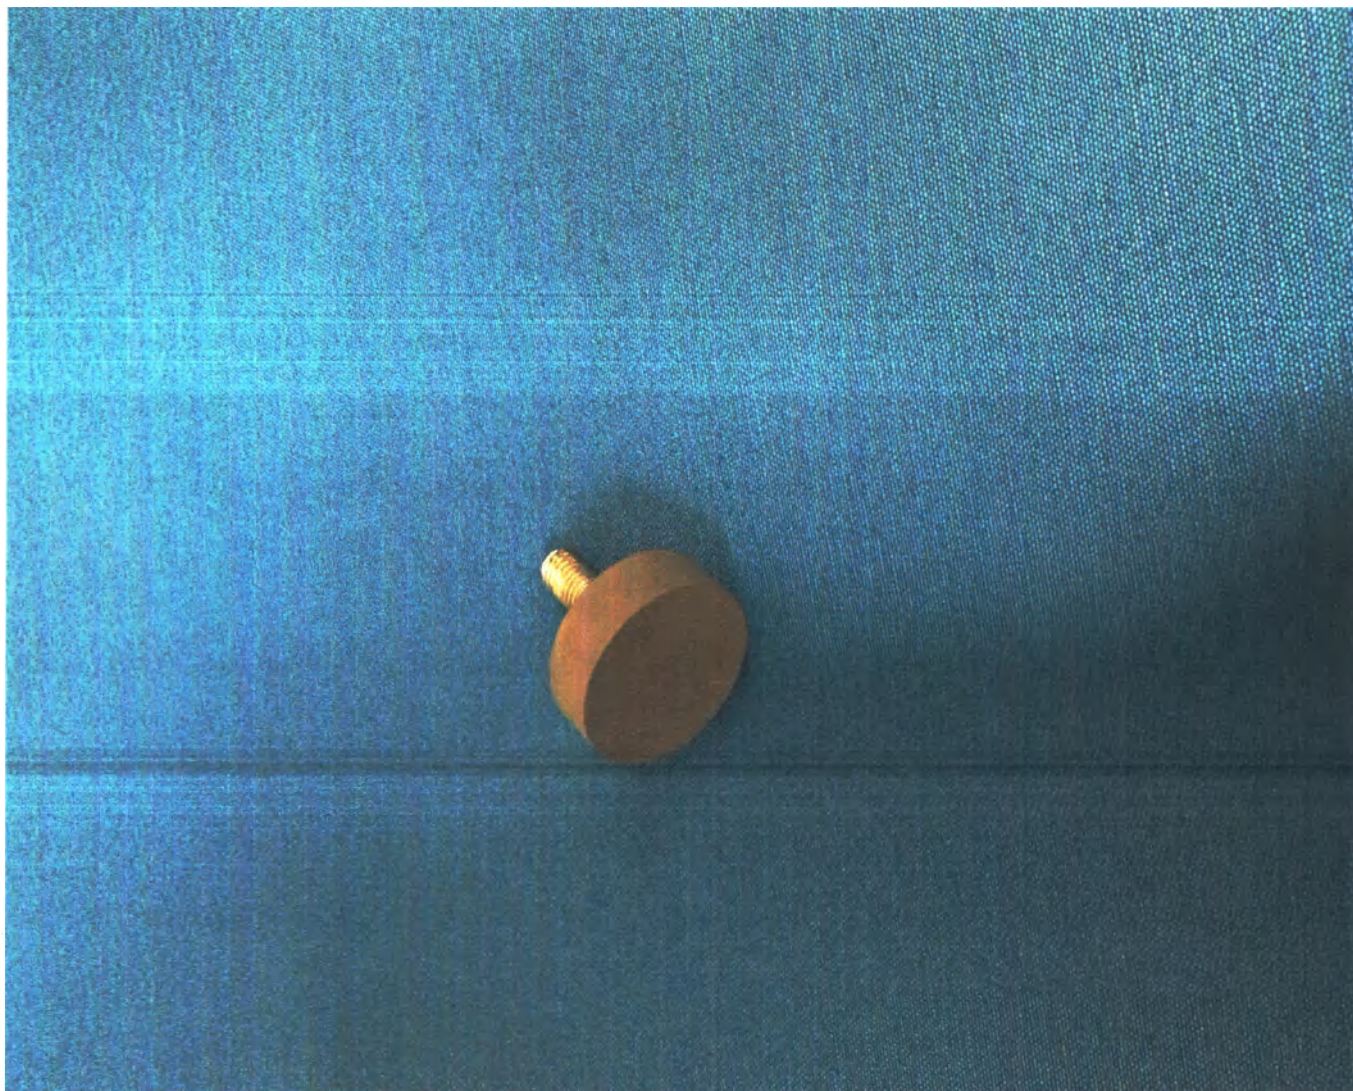

**1.16. Регулировочные опоры**

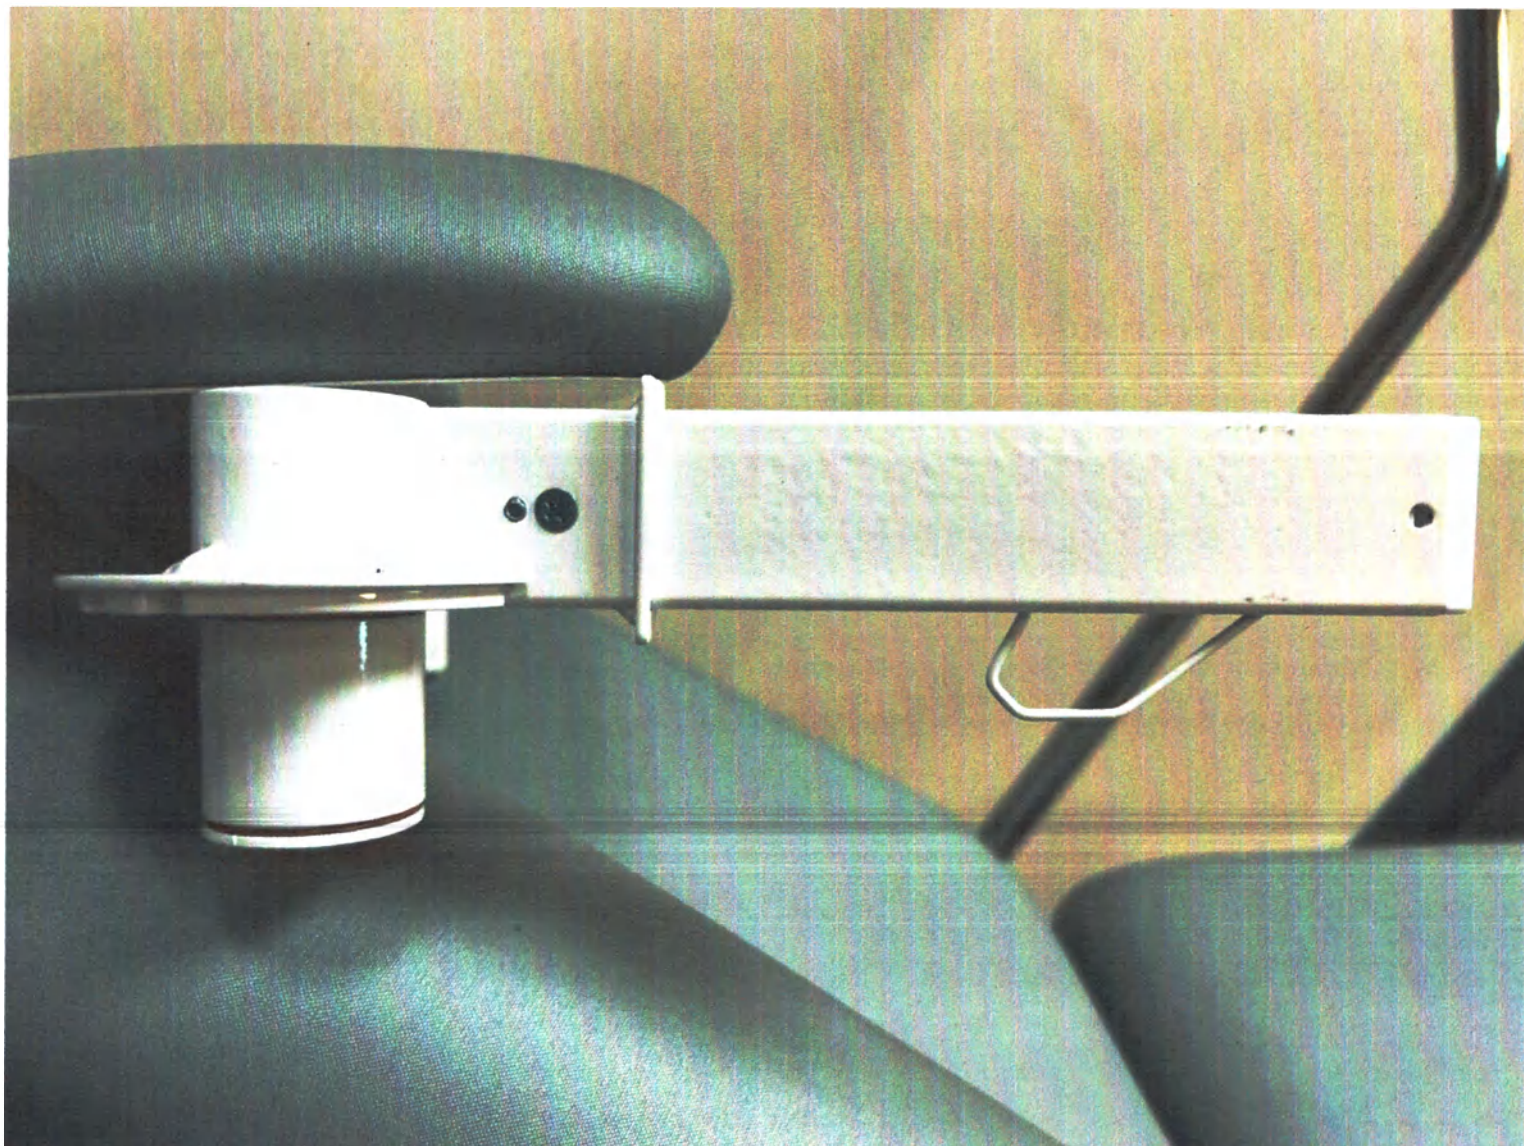

**1.17. Адаптер**



**1.18. Кабель питания**

# LOJER®

*For easy care*

Стол для осмотра и терапевтических  
процедур Carpe EX, в вариантах  
исполнения

Руководство по эксплуатации  
ID: DX021085, rev. 2 / 24.04.2024 (ru)




CE MD

LOJER  
MADE IN FINLAND


1



**2. Стол для осмотра и терапевтических процедур Capre EX2, в составе**

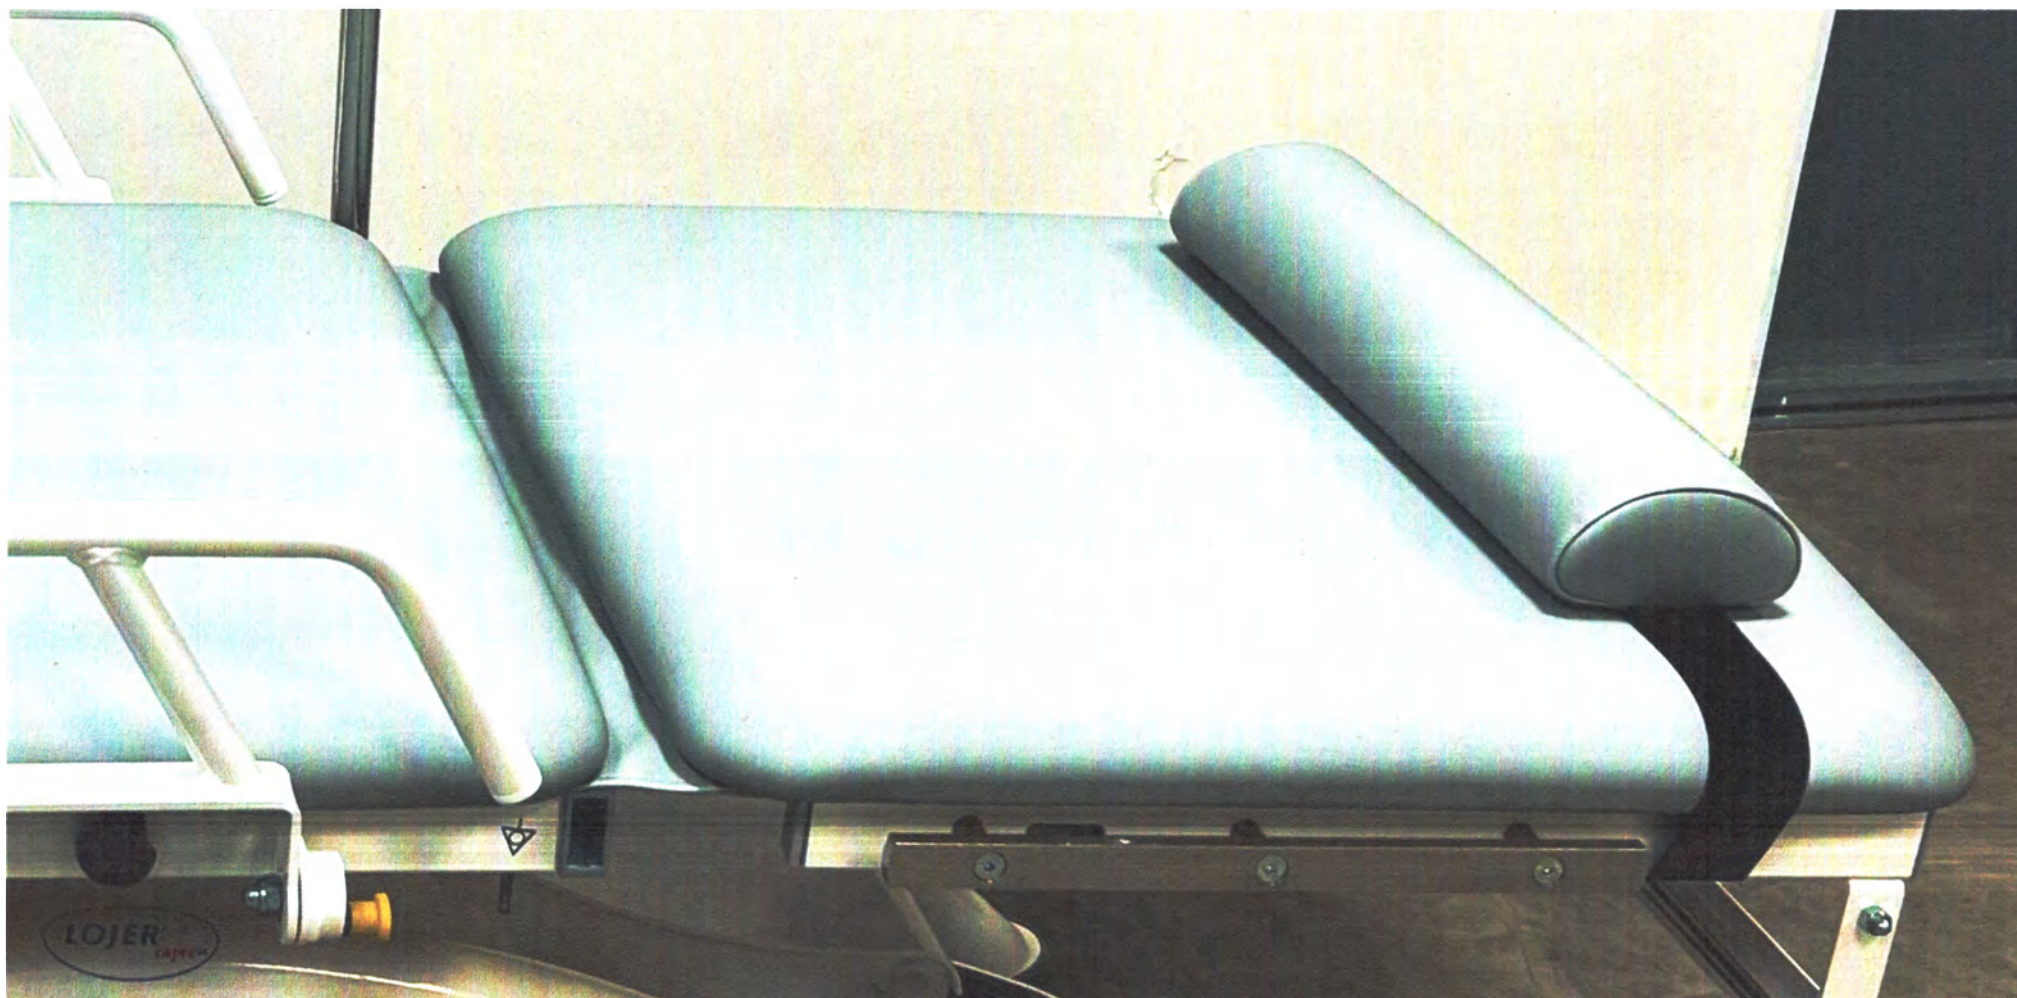


**2.1 Секция спинная**

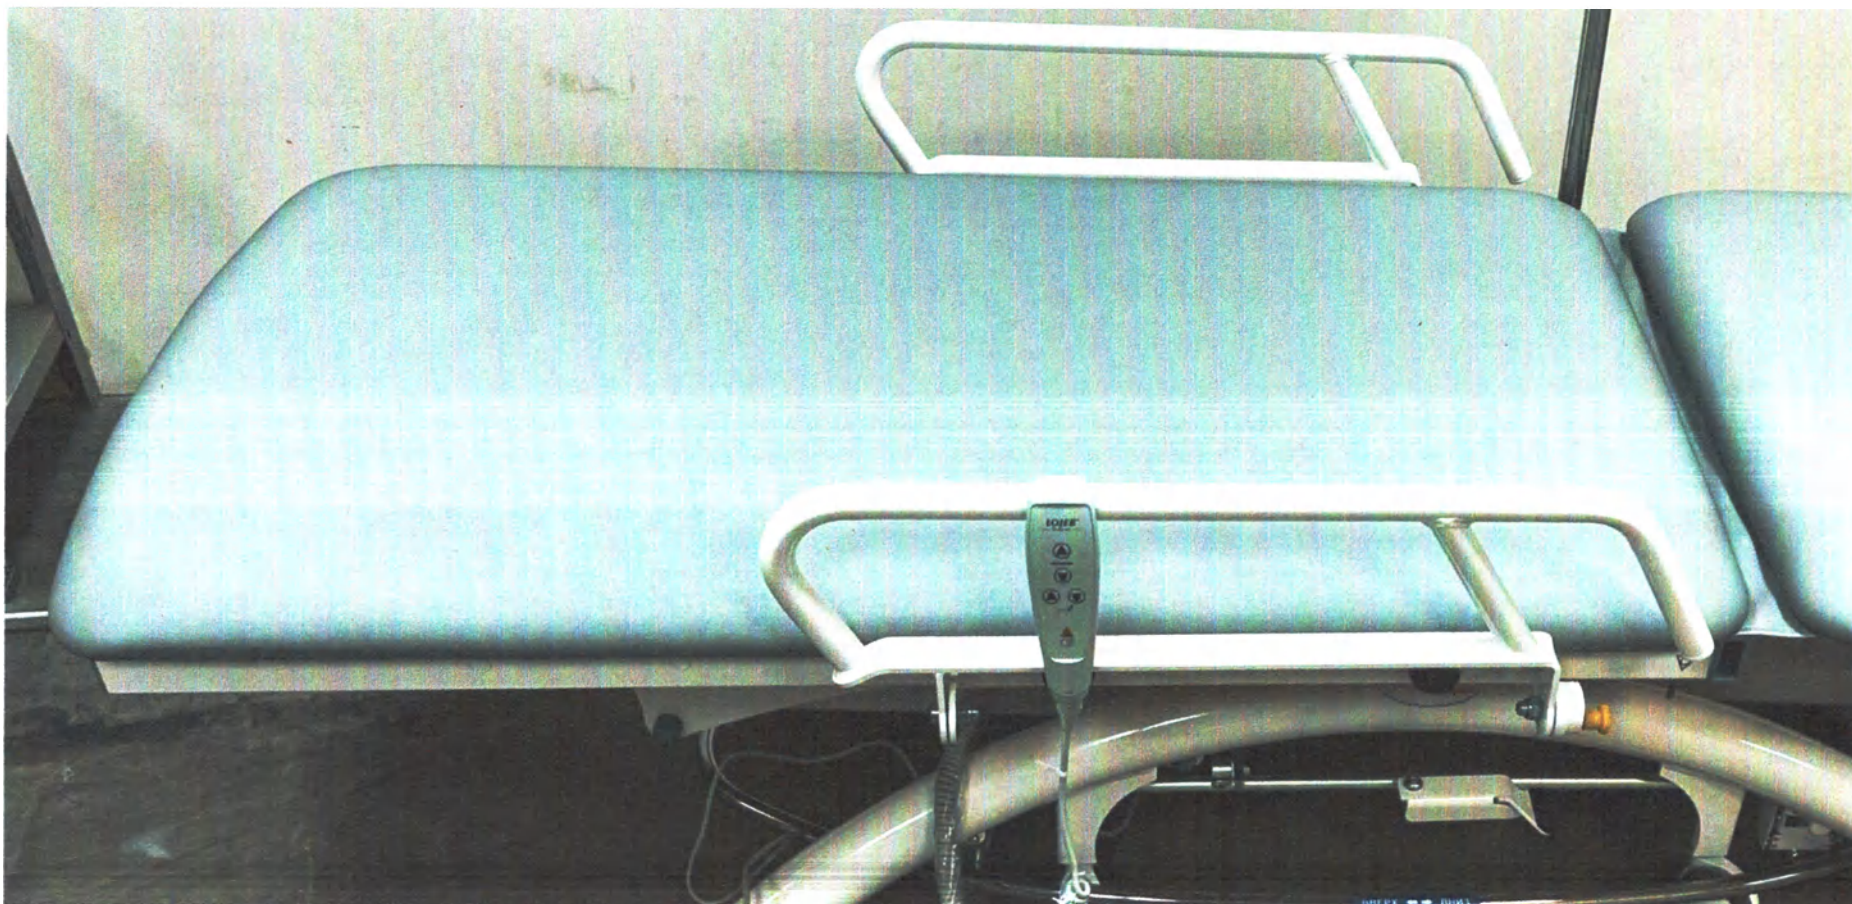

**2.2 Секция ложа**



**2.3 Держатель рулона бумаги**

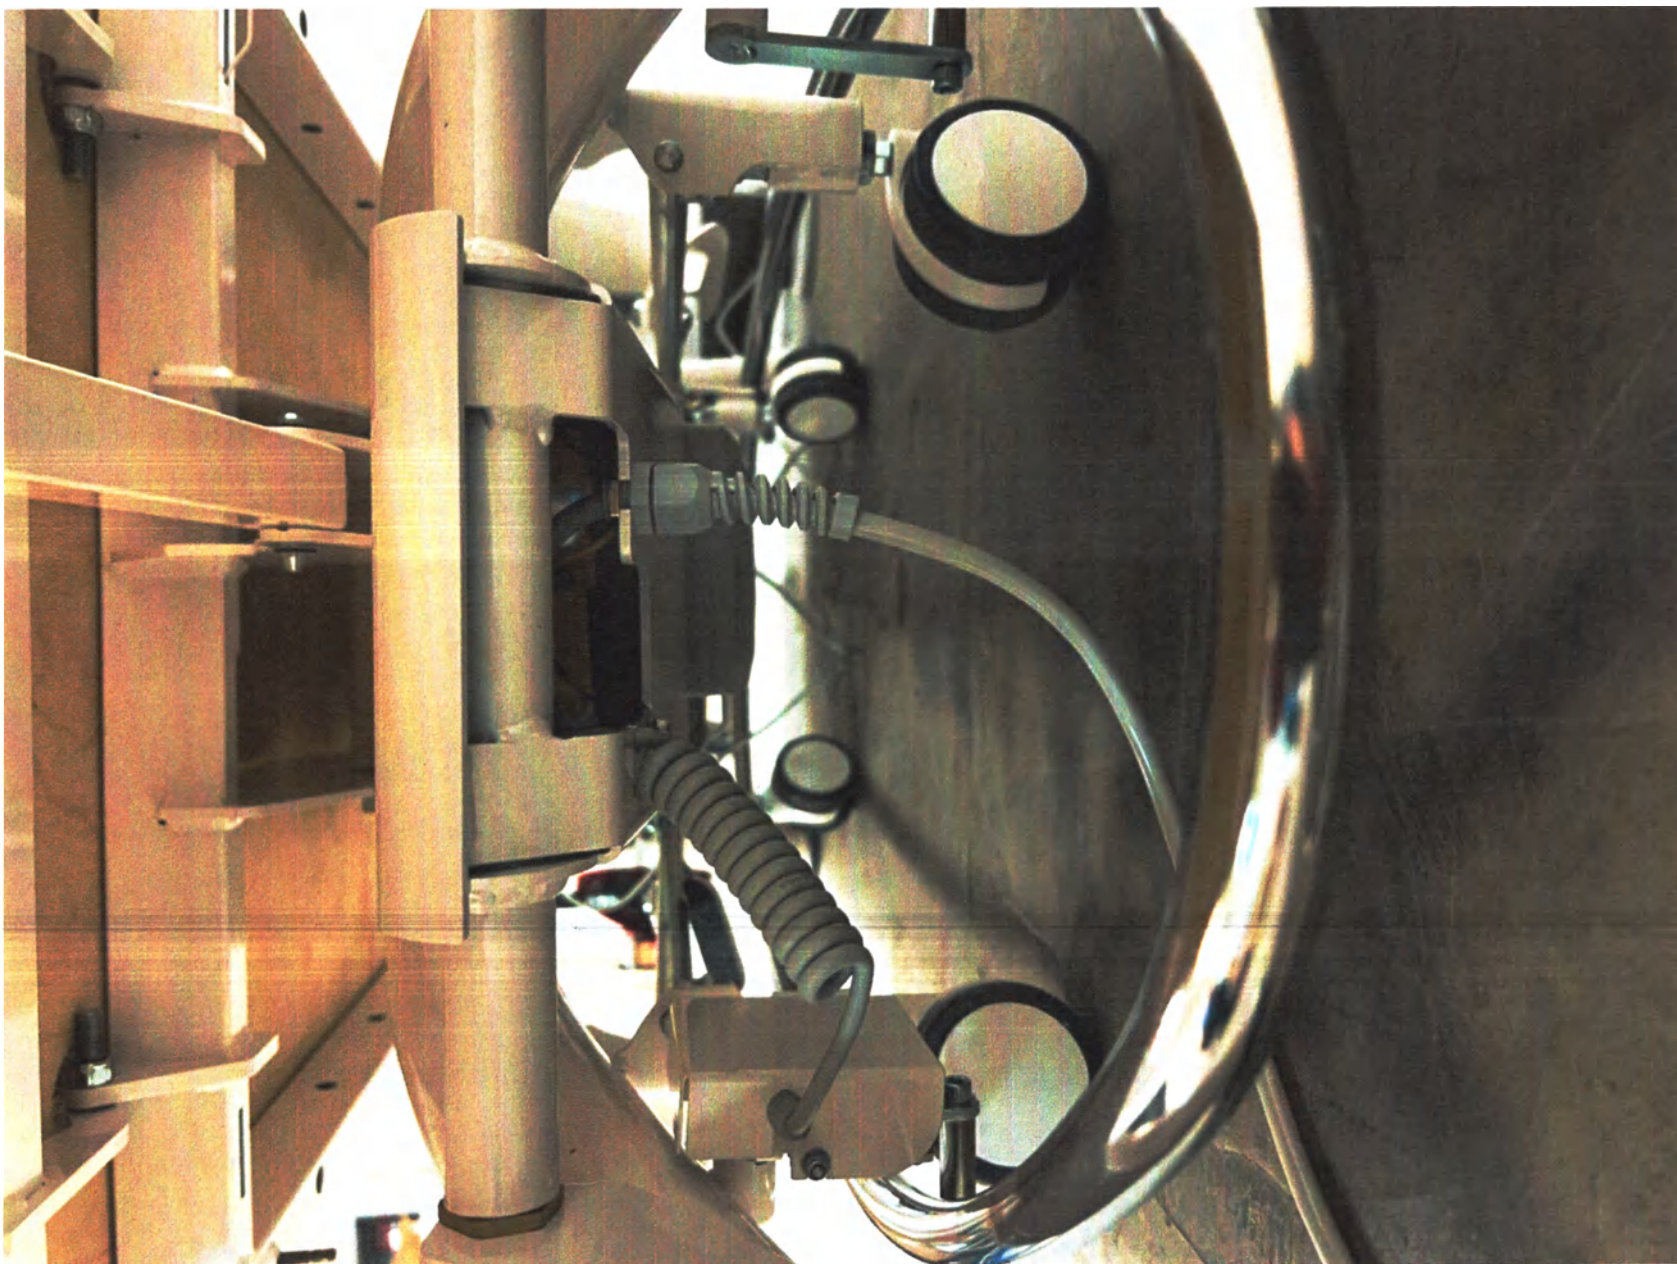


**2.4 Колеса с центральной блокировкой**




**2.5 Педаль-рама**




**2.6 Подлокотник**

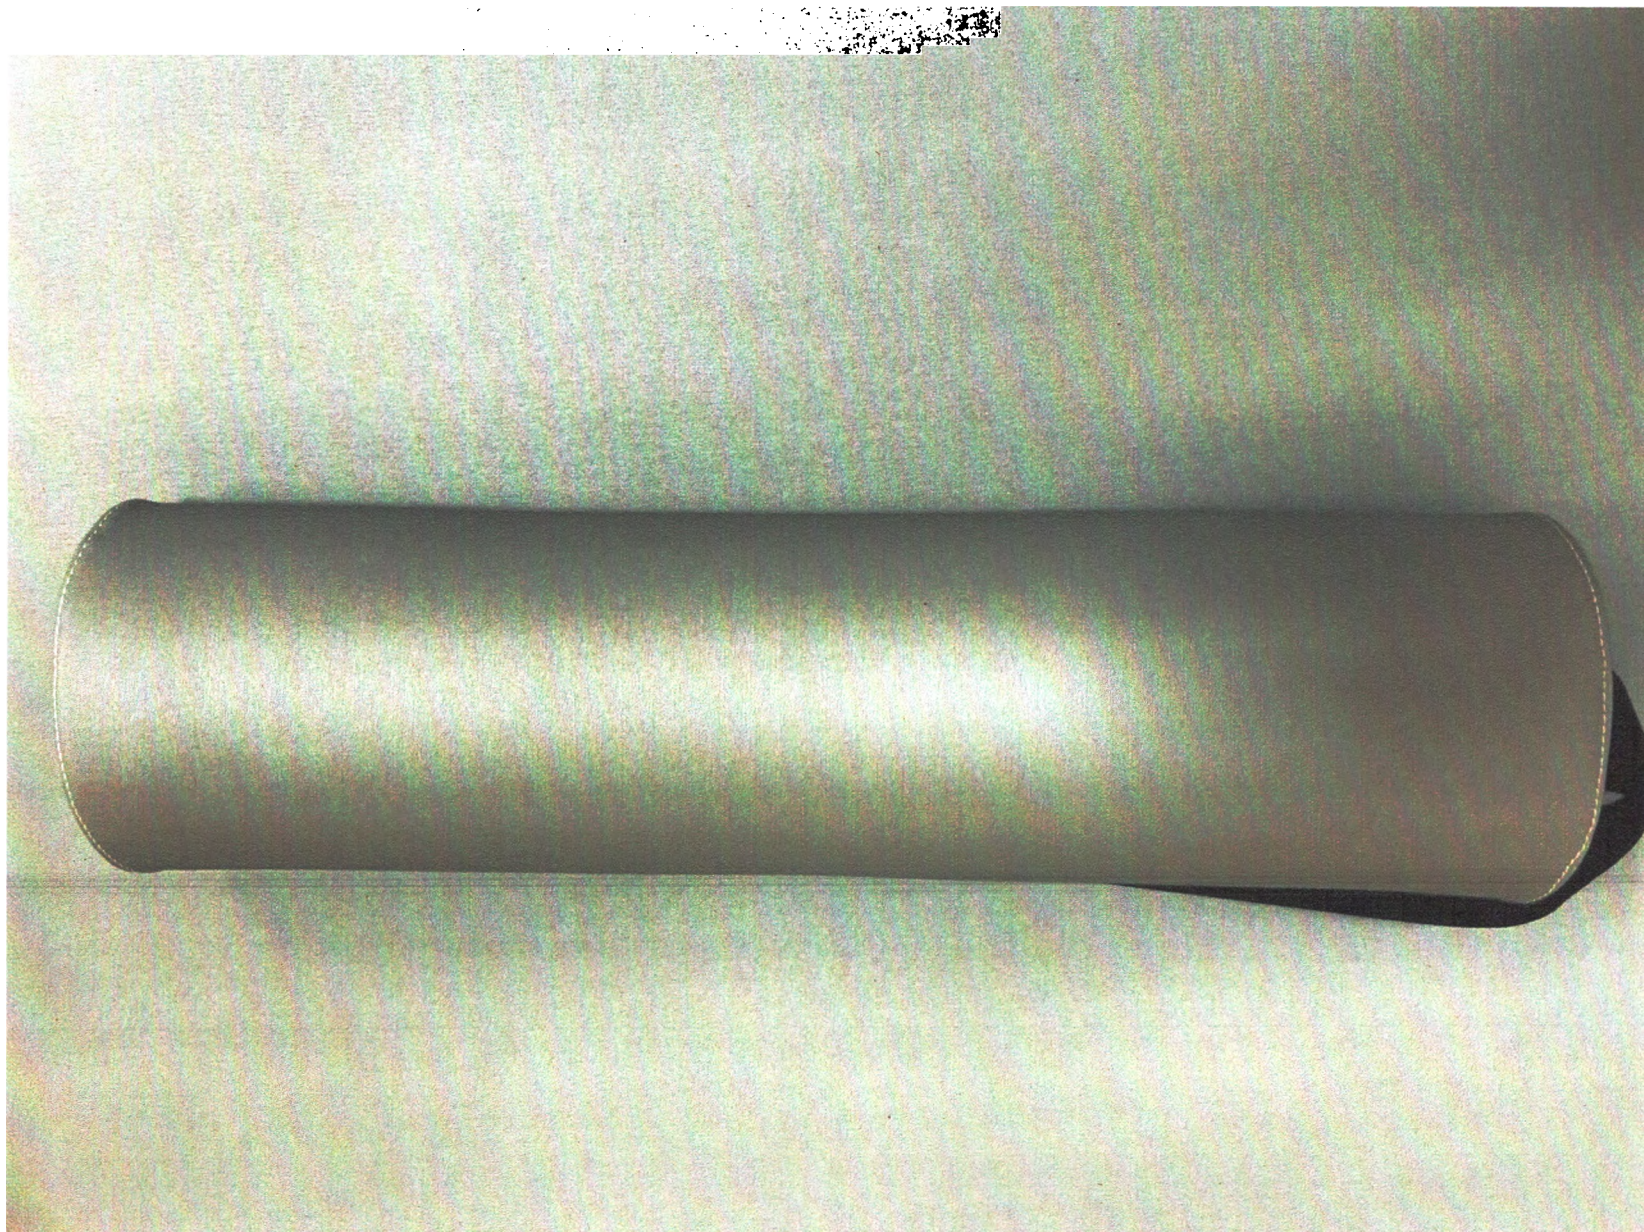


**2.7 Подушка**

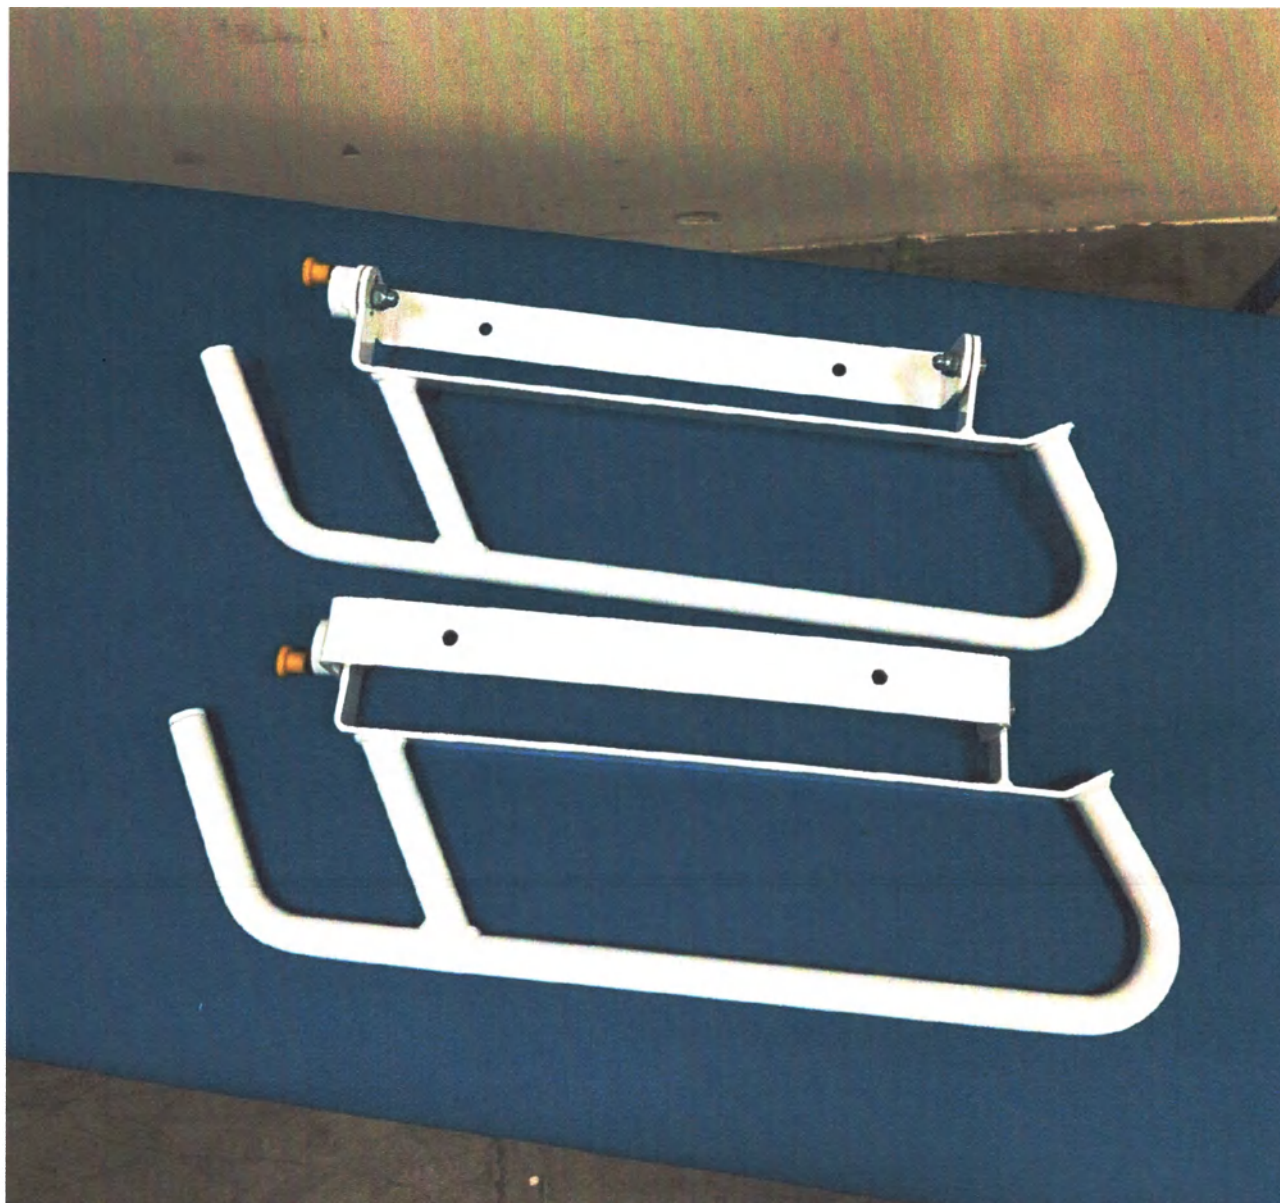


**2.8 Боковое ограждение, в составе:**

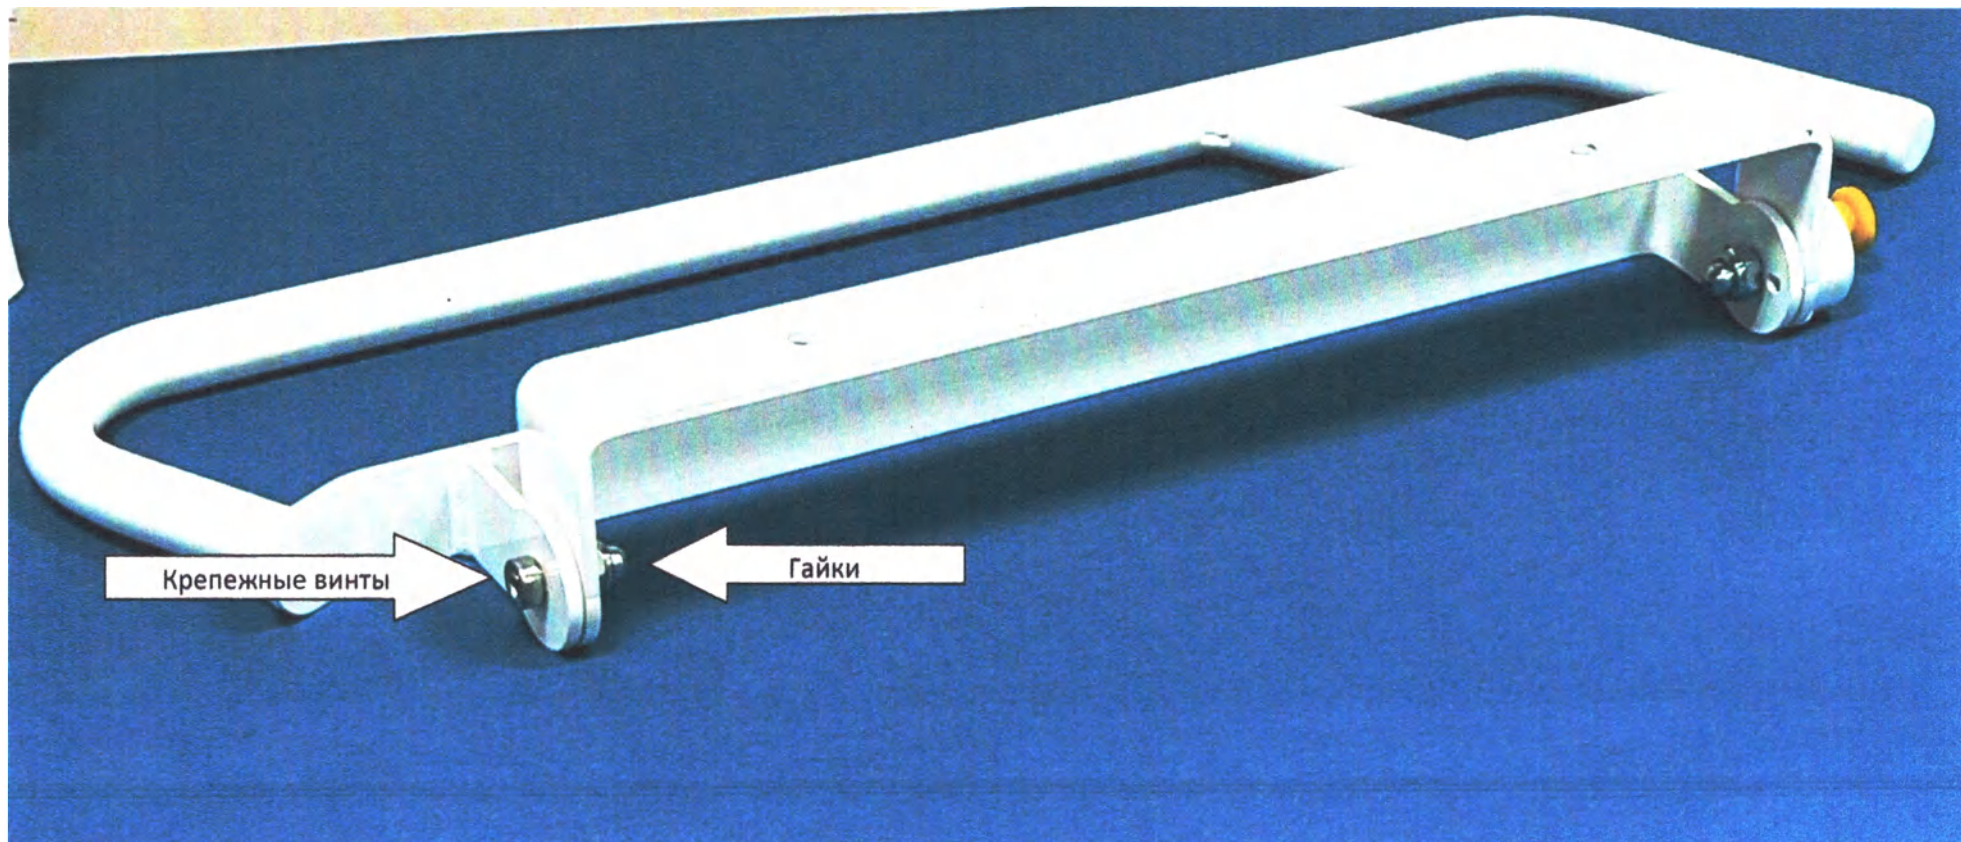


- Крепежные винты  
- Гайки

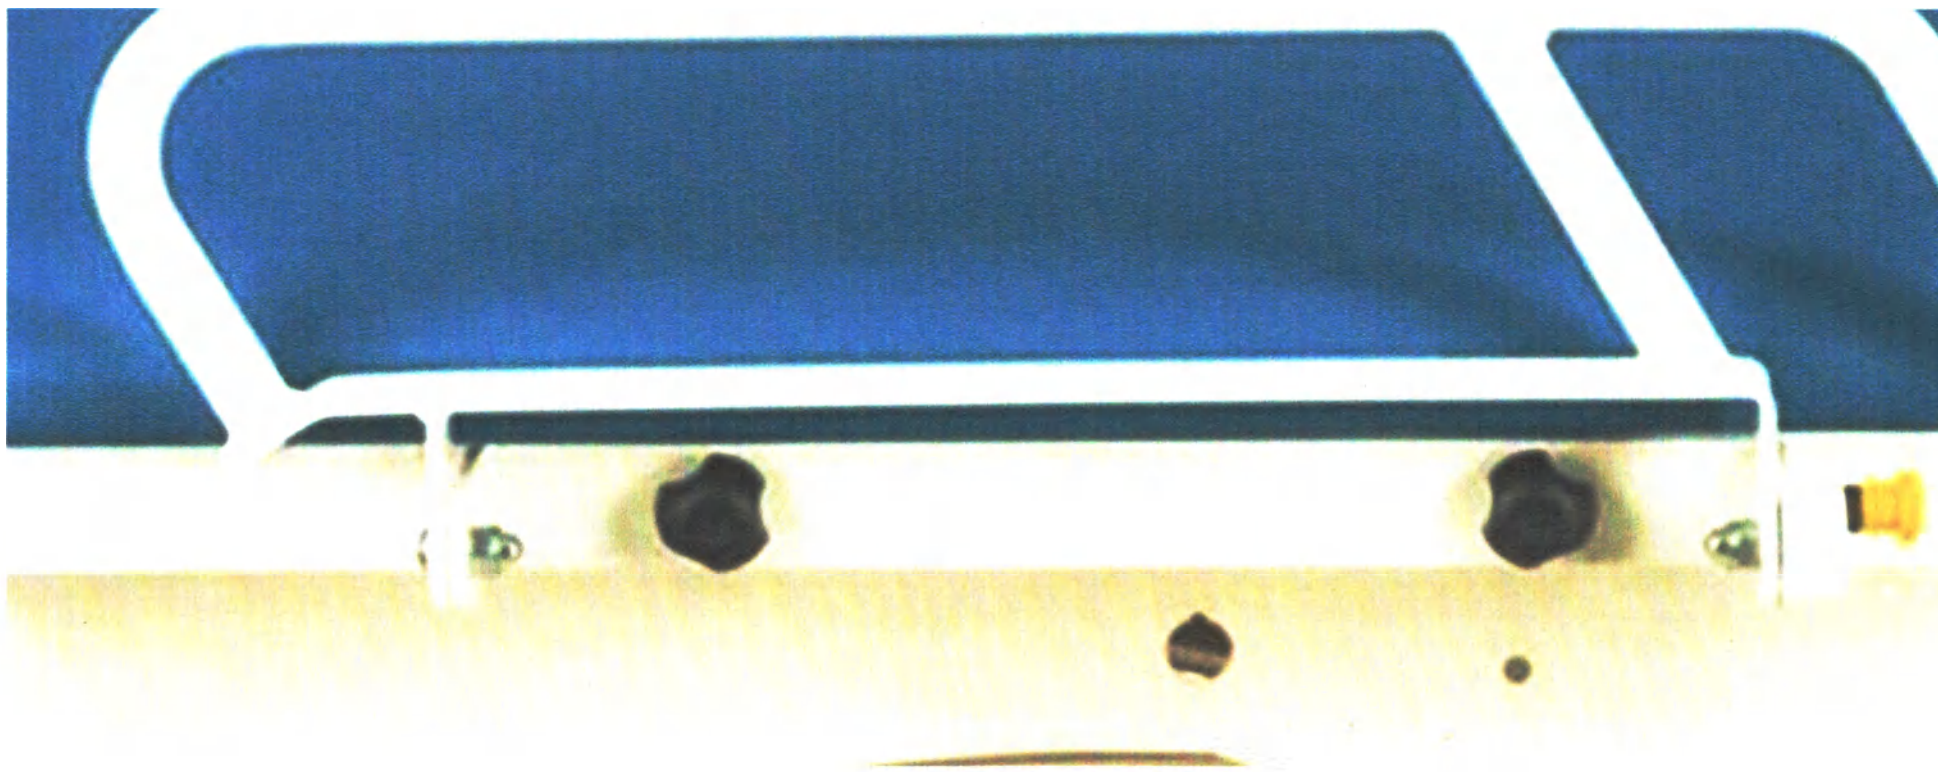


**2.9 Крышки, закрывающие отверстия для крепежных винтов для установки боковых ограждений  
(предустановленные на столе)**

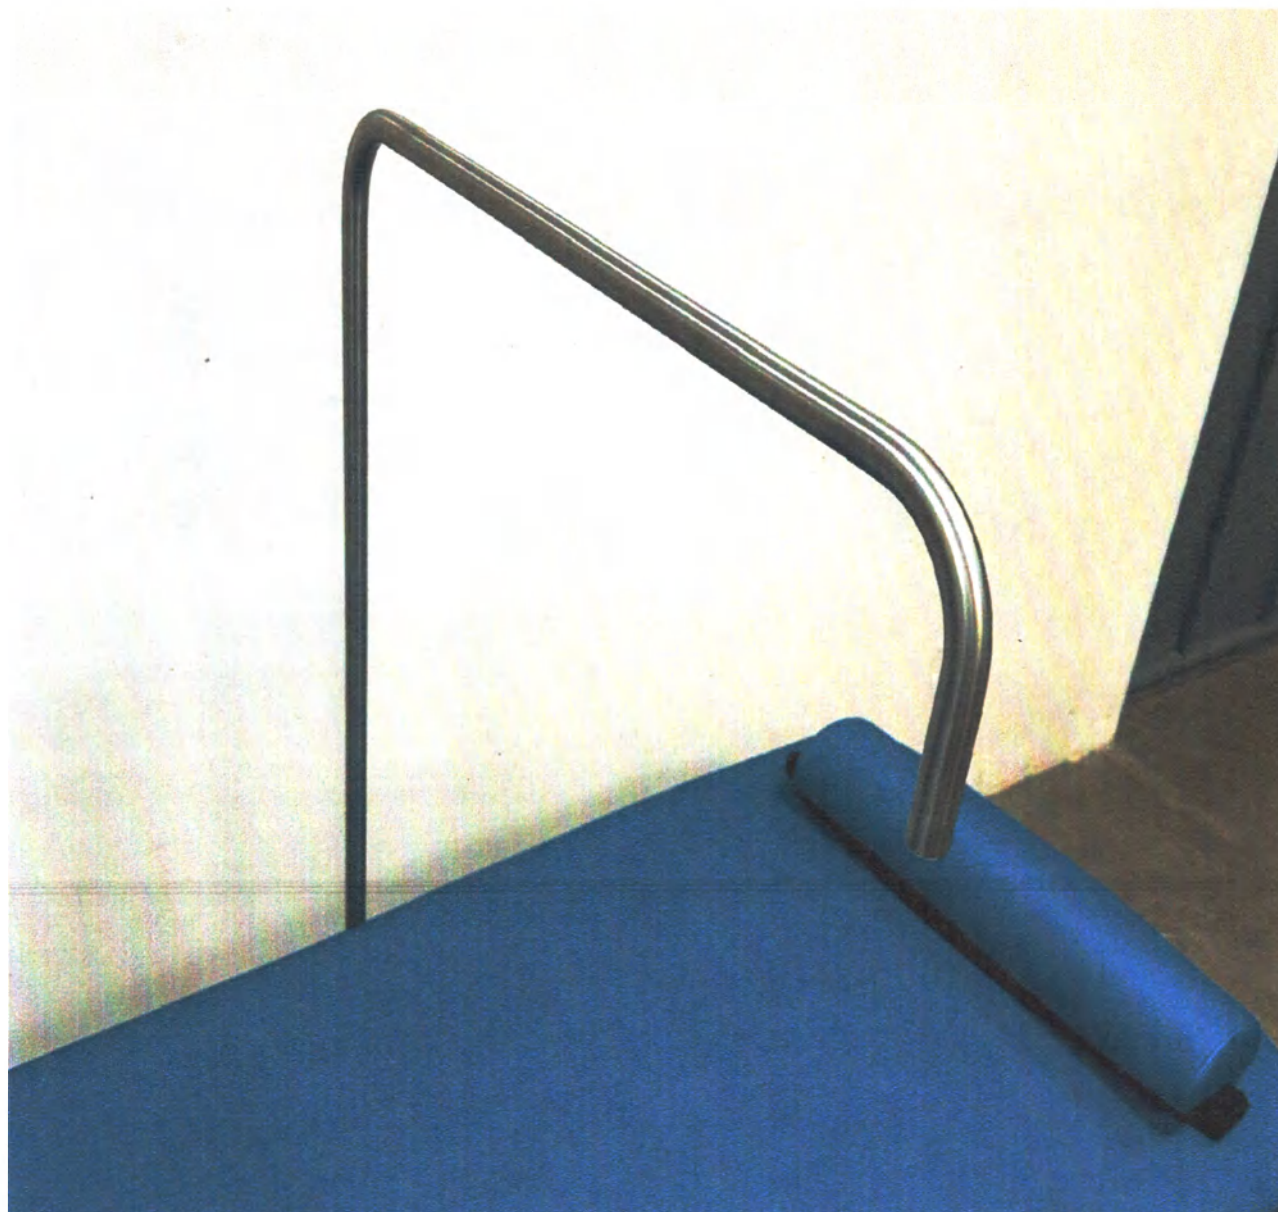


**2.10 Анестезиологическая дуга**

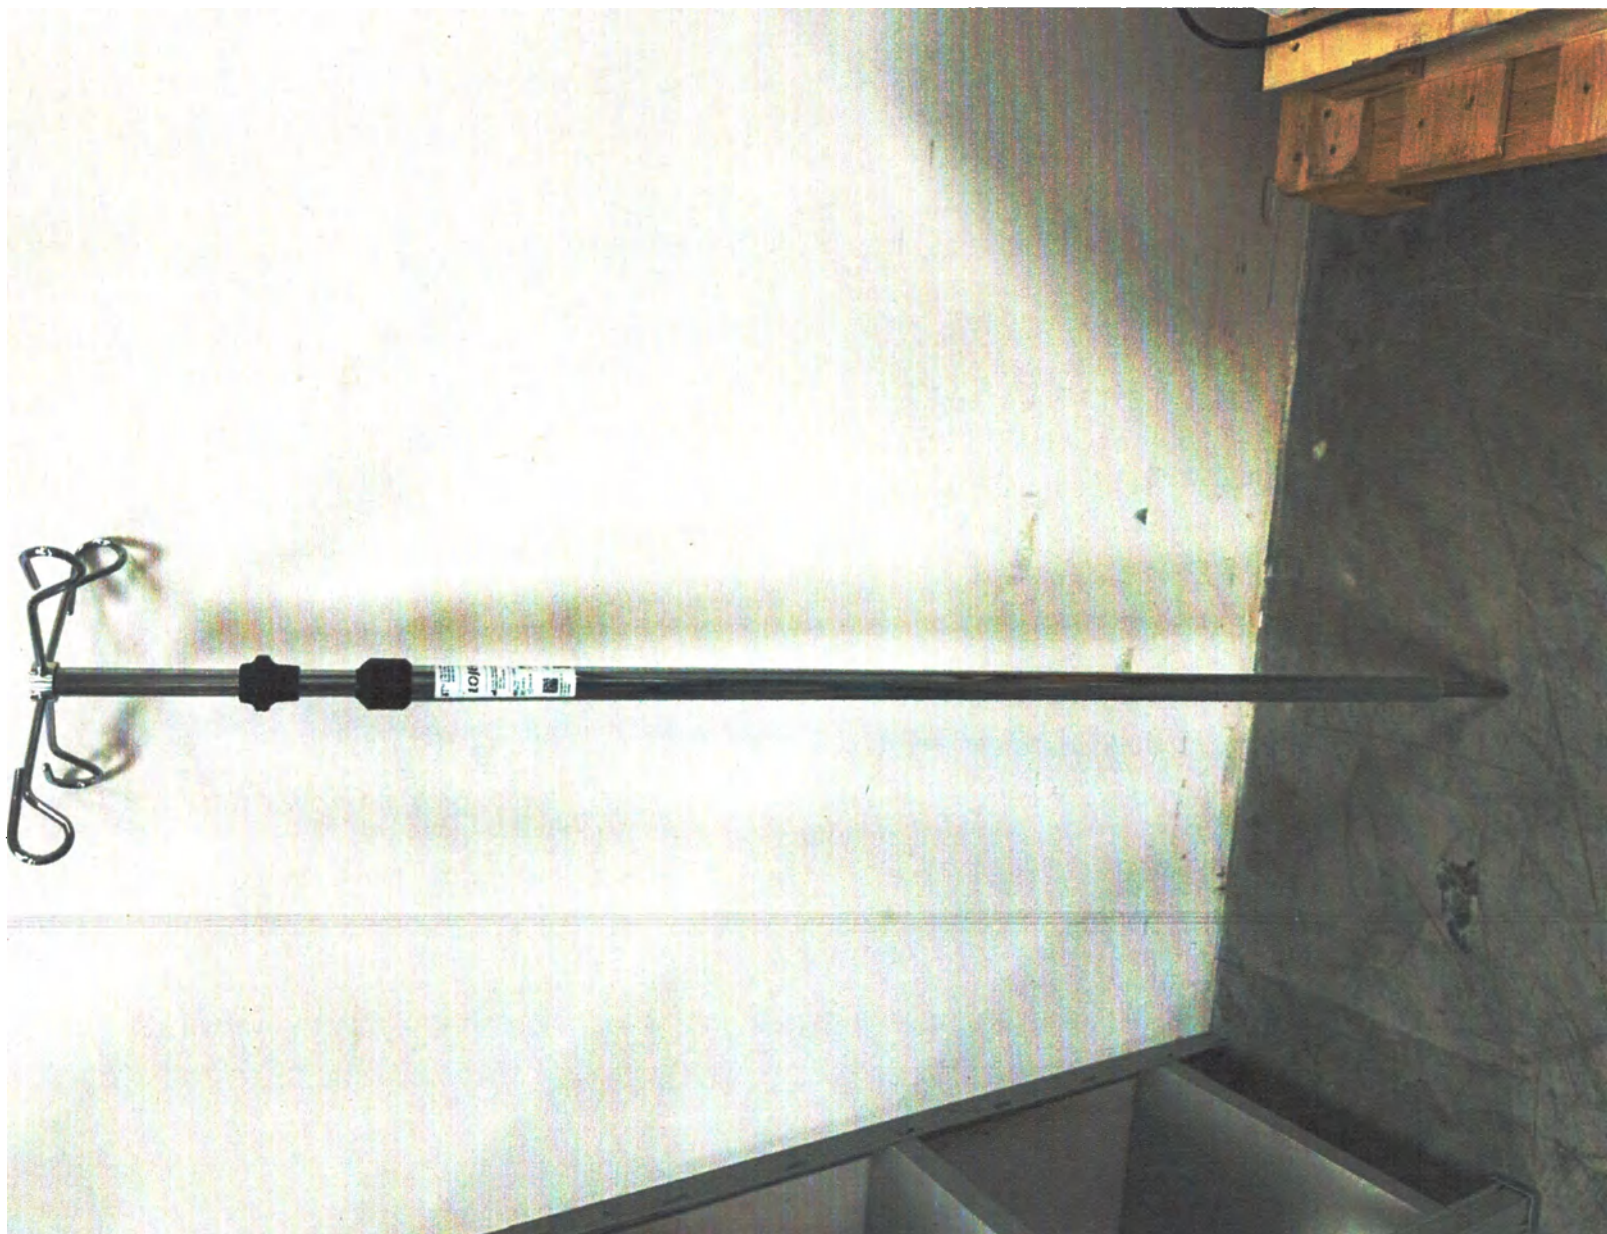

**2.11 Штатив для внутривенных вливаний прямой**

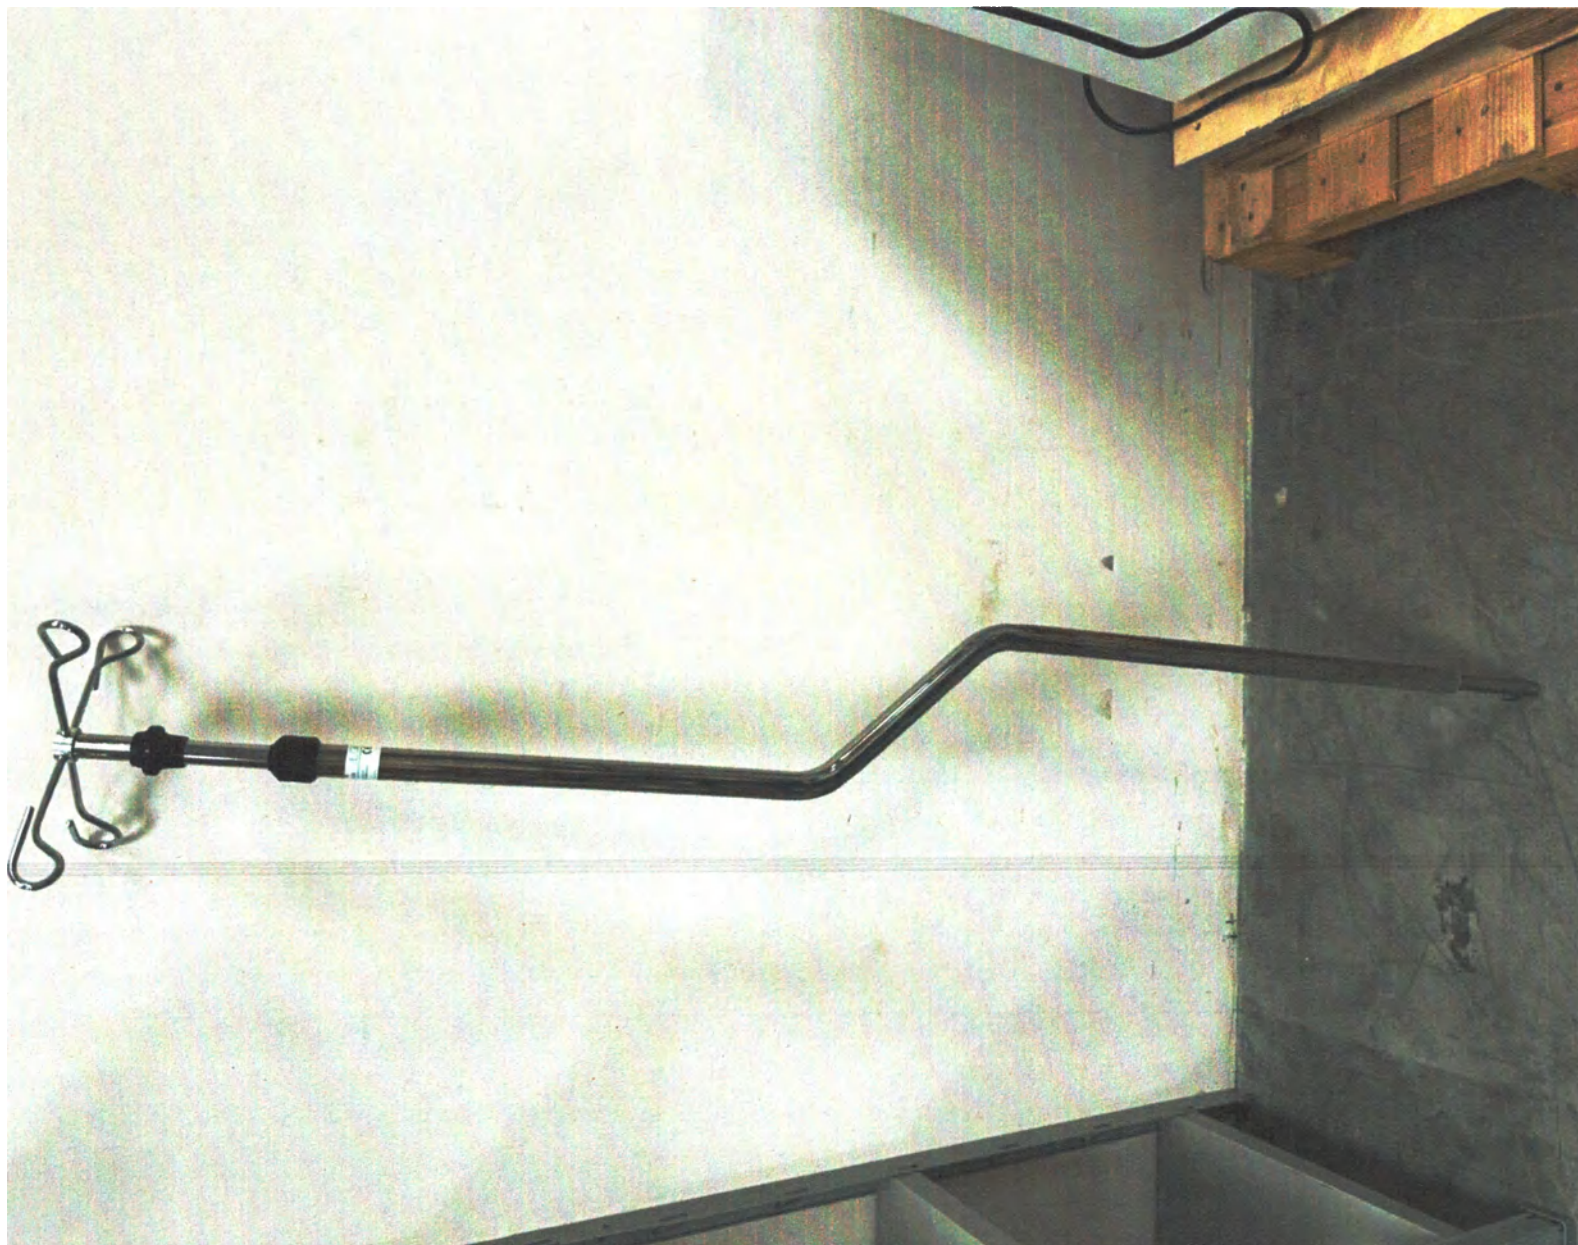

**2.12 Штатив для внутривенных вливаний изогнутый**

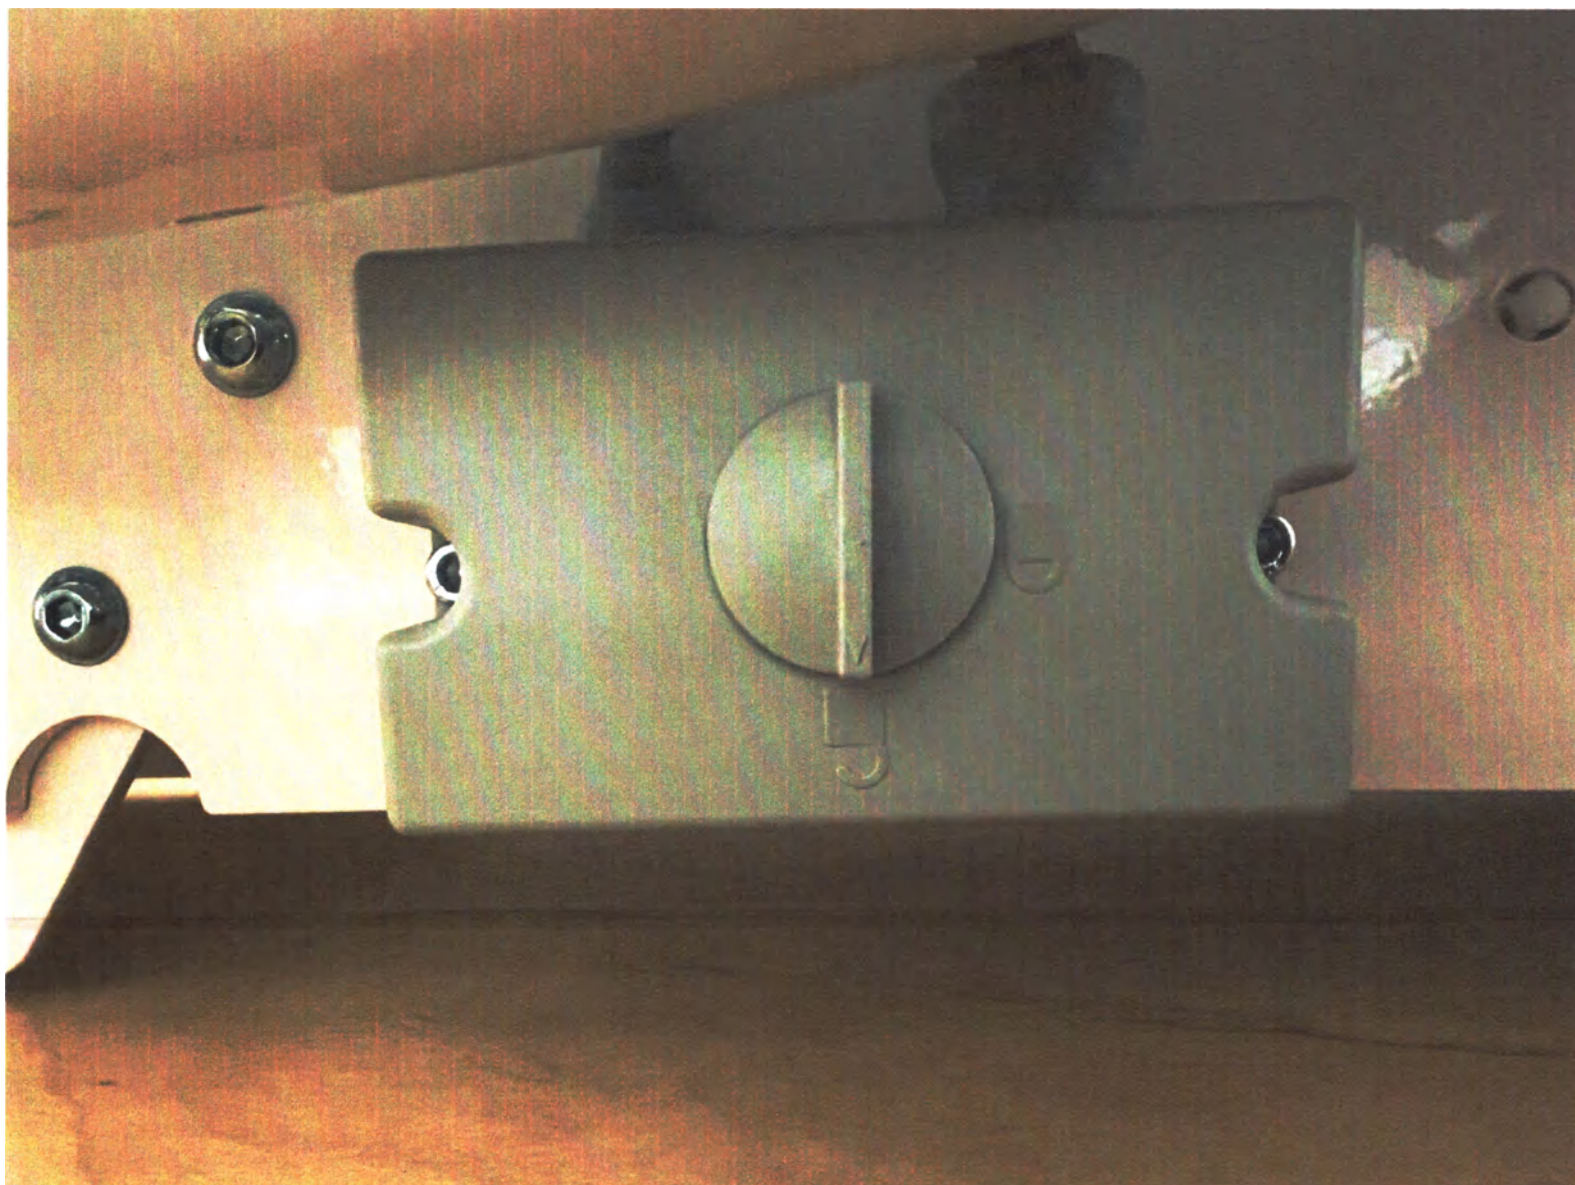

**2.13 Защитный выключатель**




2.14 Пульт ножного управления




**2.15 Пульт ручного управления**



**2.16 Рельс для установки дополнительных приспособлений**

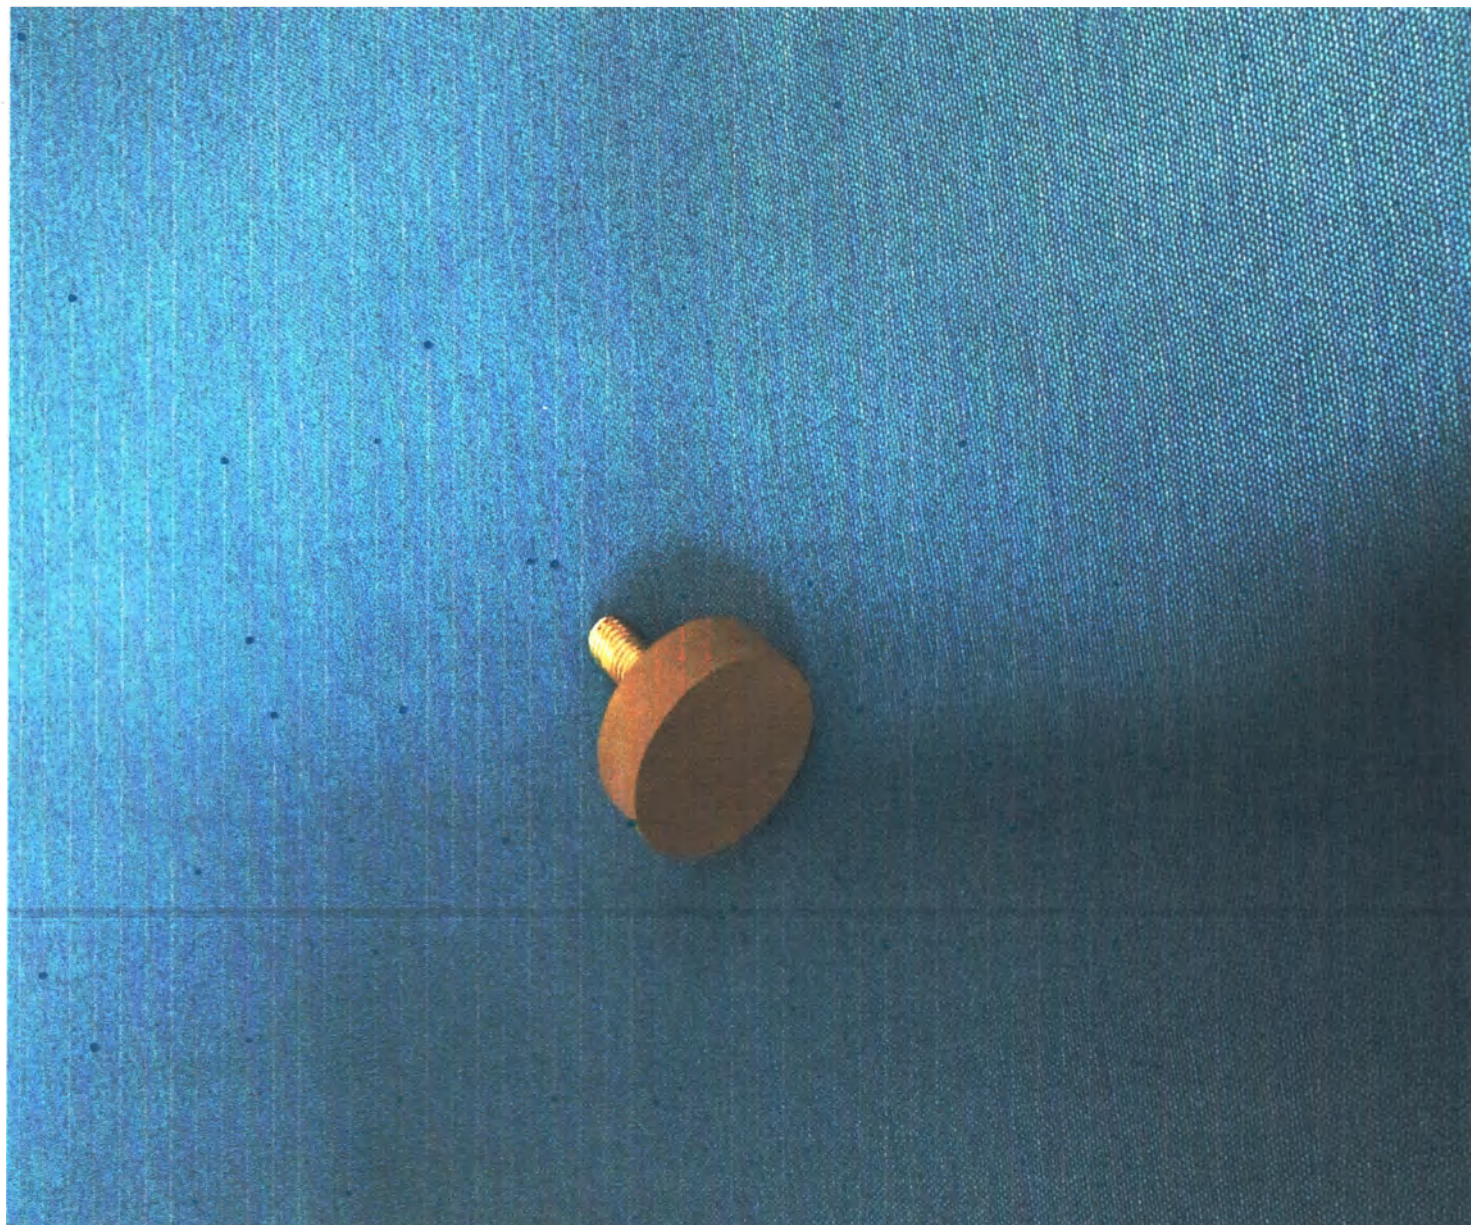

**2.17 Регулировочные опоры**

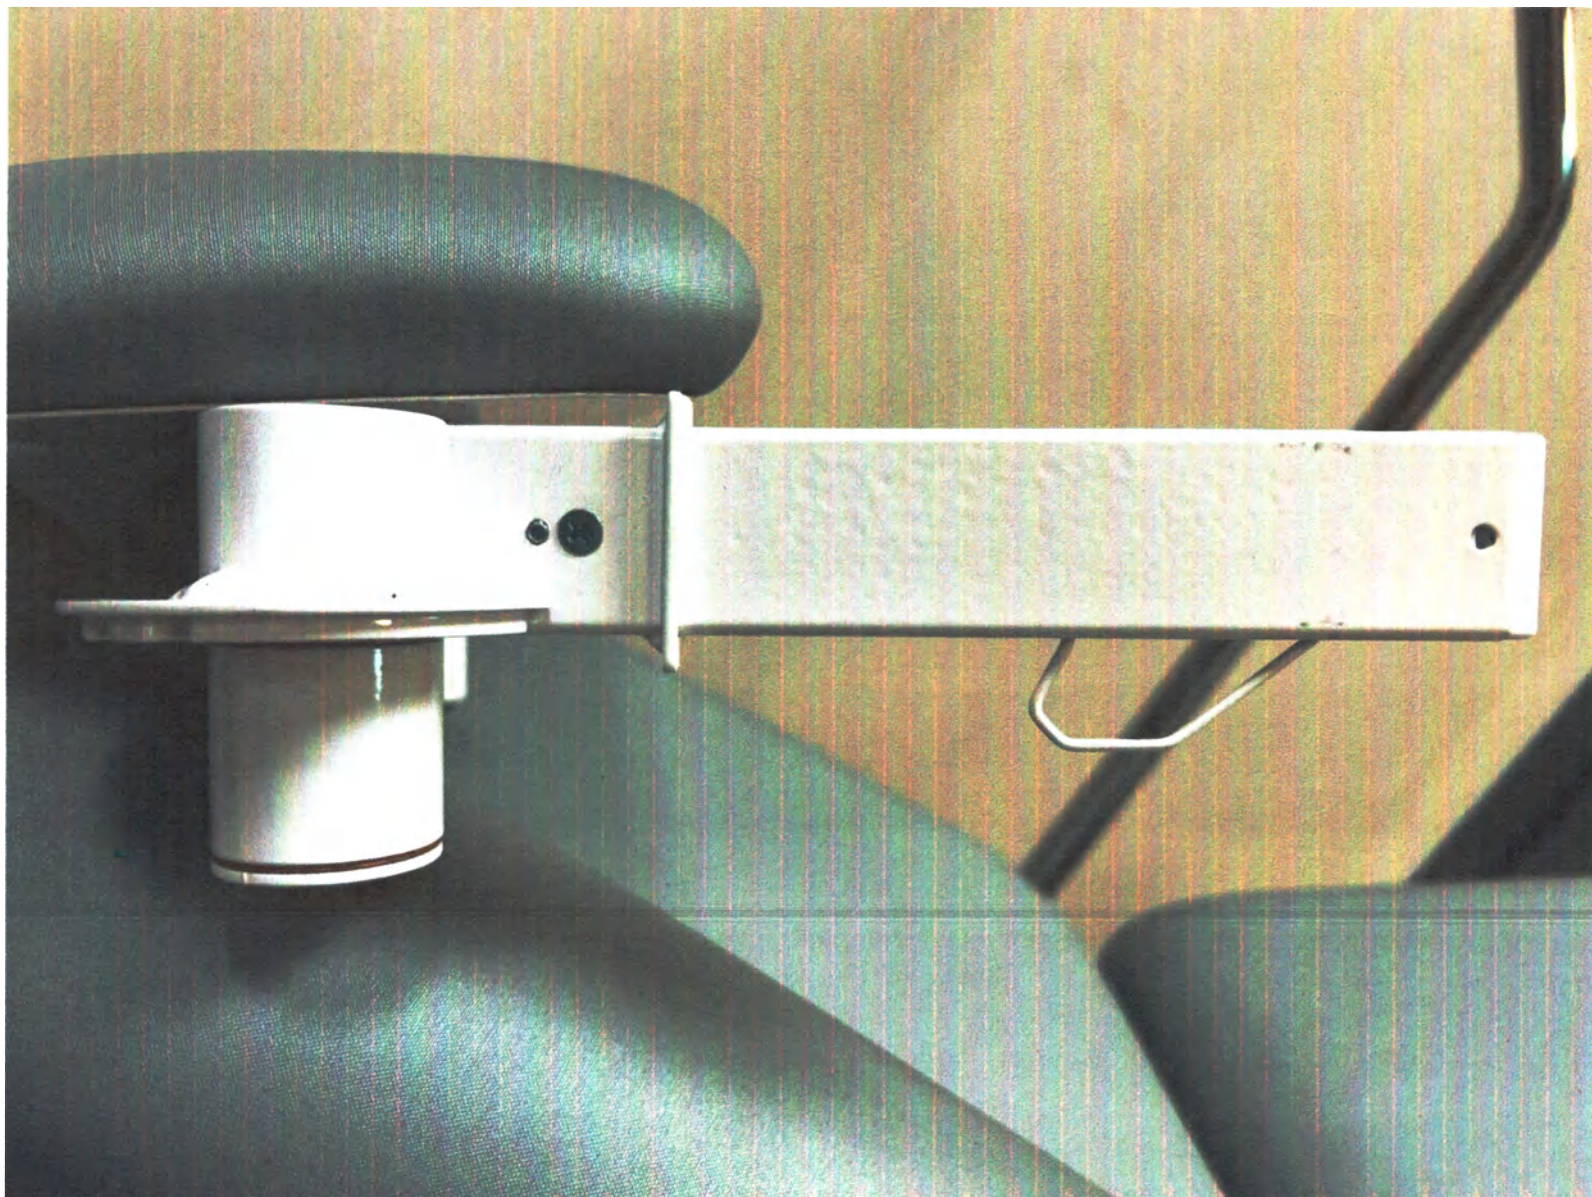

**2.18 Адаптер**



**2.19 Кабель питания**

# LOJER®

*For easy care*

Стол для осмотра и терапевтических  
процедур Carpe EX, в вариантах  
исполнения

Руководство по эксплуатации  
ID: DX021085, rev. 2 / 24.04.2024 (ru)



CE MD



1

## Макеты маркировки медицинского изделия



Маркировка:


Стол для осмотра и терапевтических процедур Capre EX1




Маркировка:  
Стол для осмотра и терапевтических процедур Capre EX2




Маркировка:  
 Штатив для внутривенных вливаний прямой

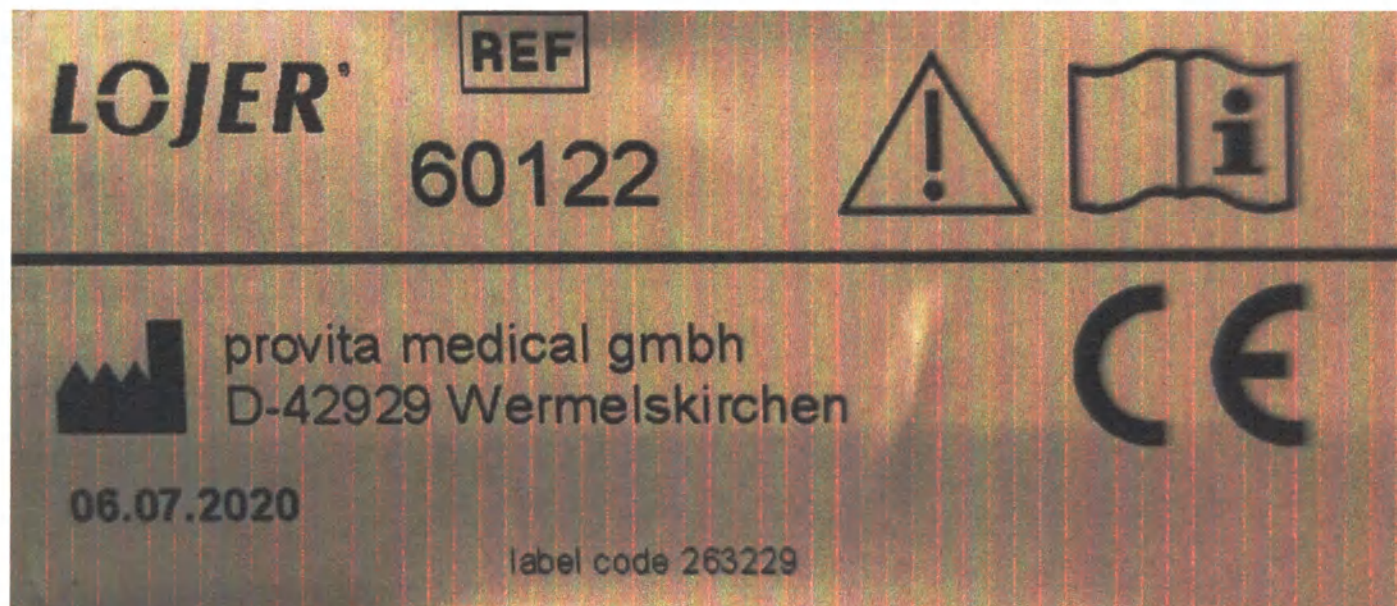

Маркировка:  
Штатив для внутривенных вливаний изогнутый

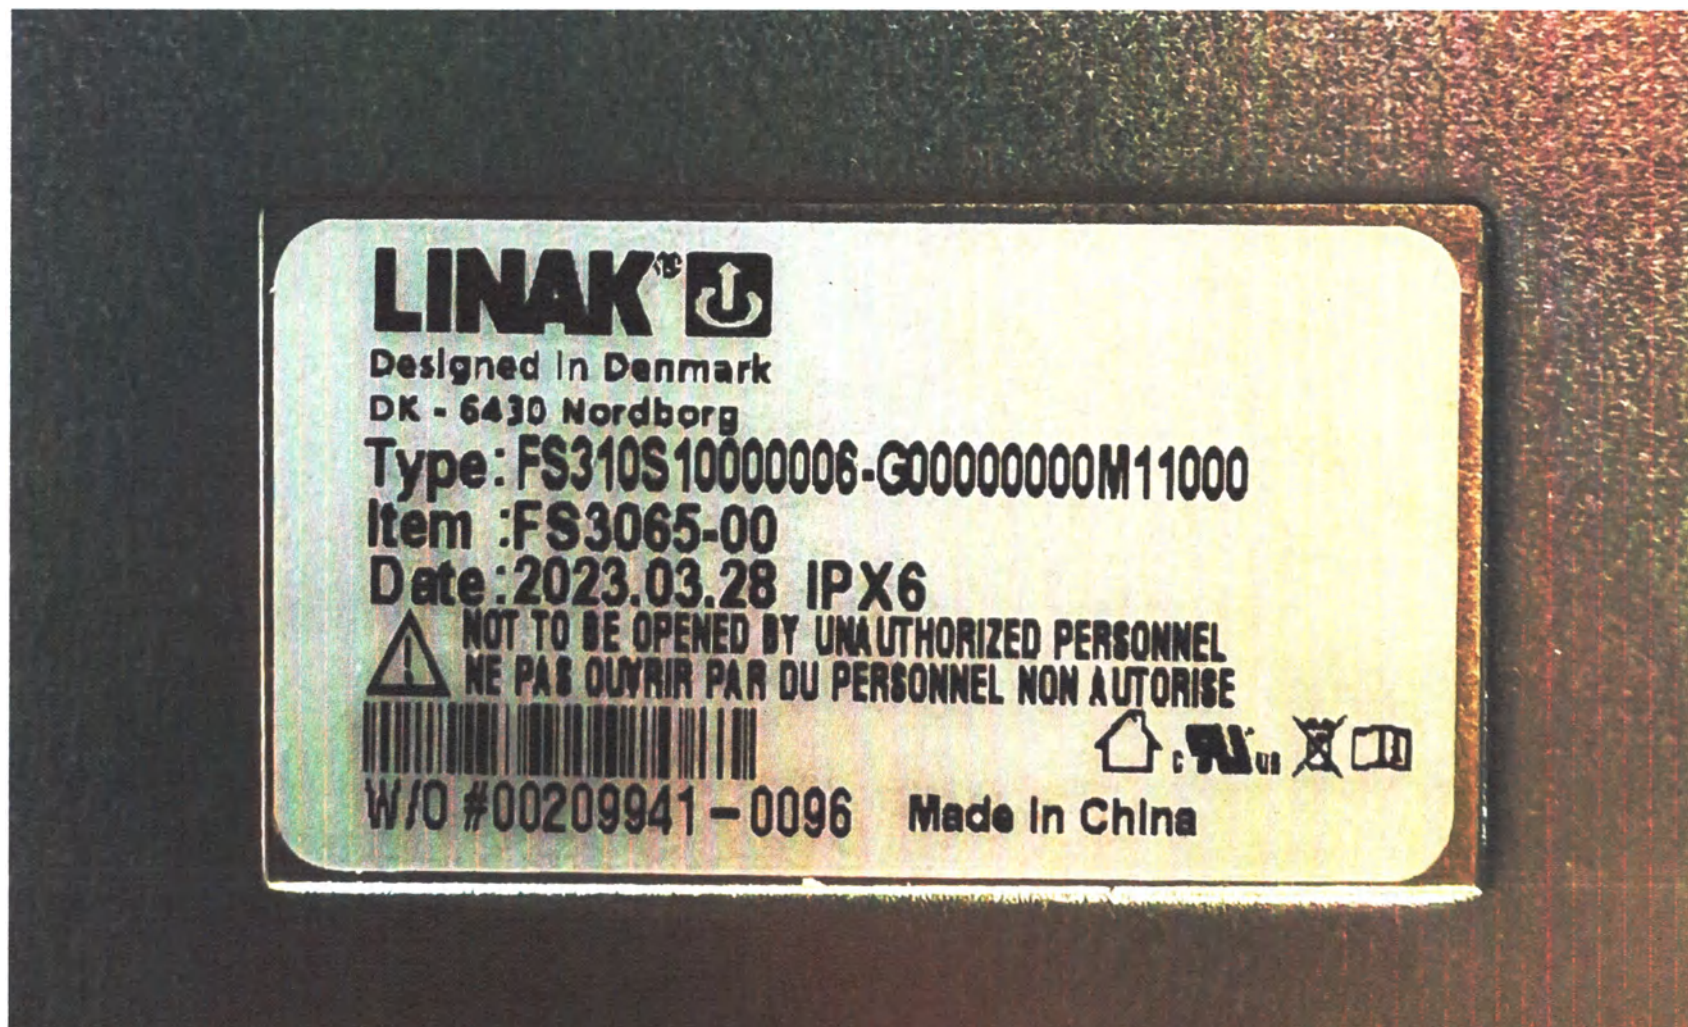

Маркировка:  
Пульт ножного управления (Сарге EX1)

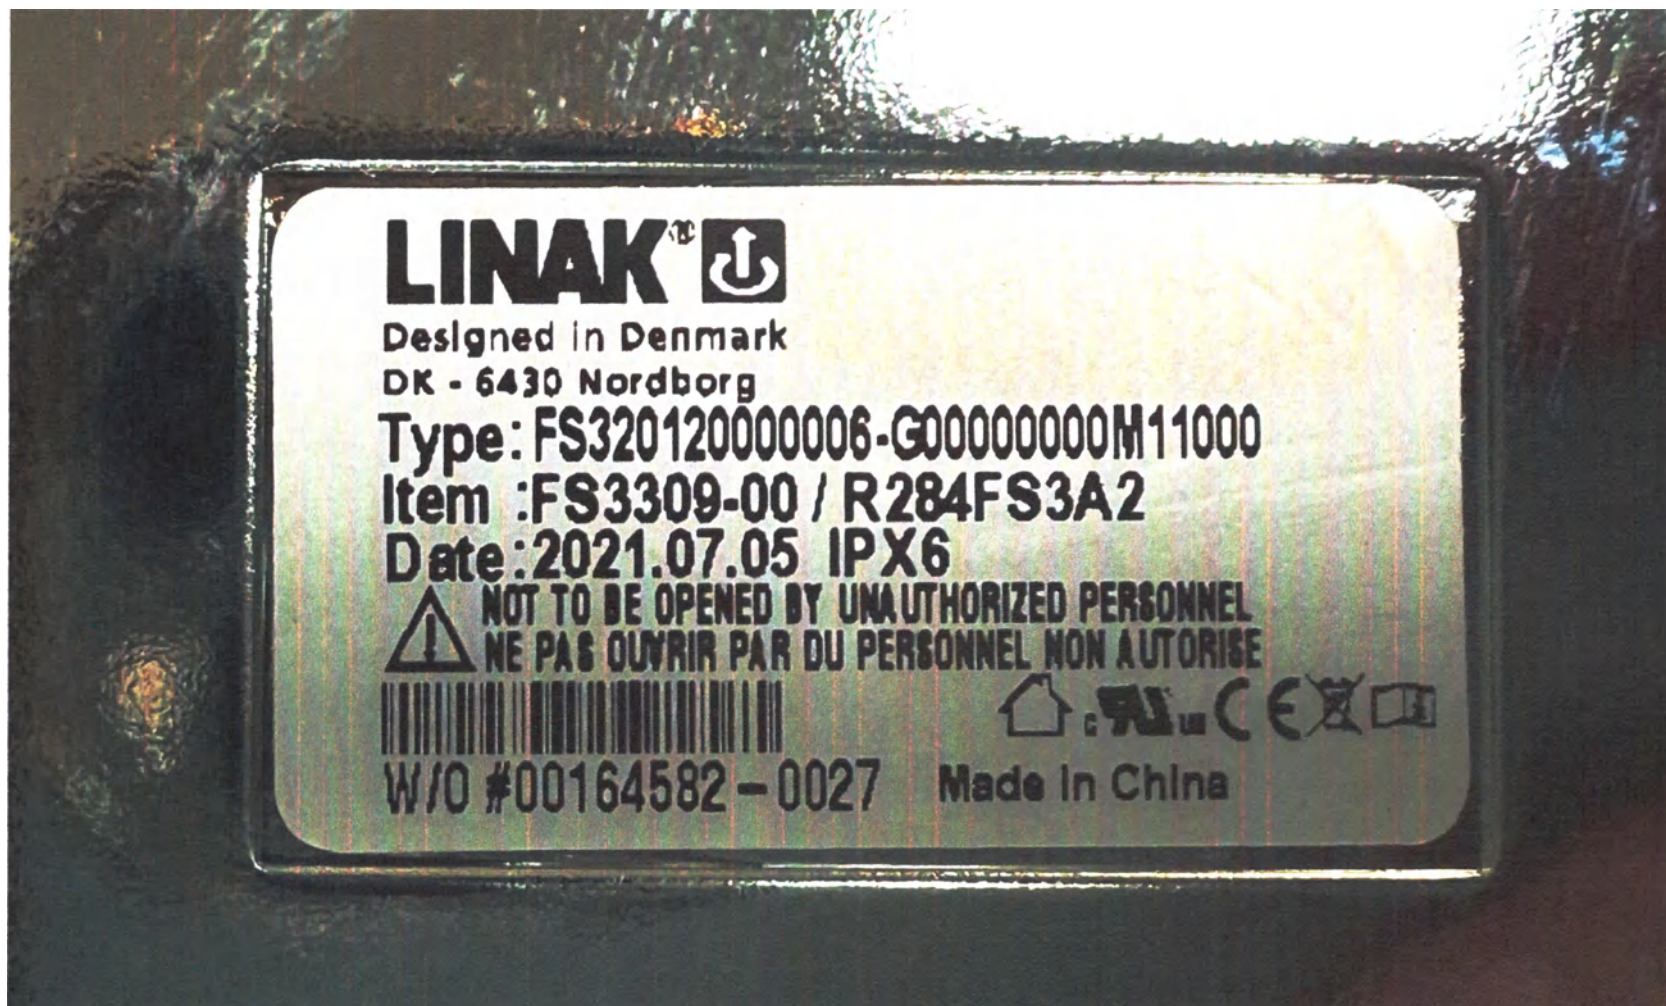

Маркировка:  
Пульт ногоного управления (Capre EX2)



Маркировка:  
Пульт ручного управления

**LINAK®** 

Designed in Denmark

DK - 6430 Nordborg

Type : ACL403500XX0805

Item : ACL024-01

Date : 2024.01.23 IPX4



NOT TO BE OPENED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL  
NE PAS OUVRIR PAR DU PERSONNEL NON AUTORISE

Made in Denmark



W/O# 31588117 – 0031



Маркировка:  
Защитный выключатель

## Упаковка медицинского изделия



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 53 листов.  
Генеральный директор  
ООО «Лойер Медикал»  
Самсонов В.Ю.

