

УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО «Альгимед Техно»



В.Н. Ластовская

» сентябрь 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система для Масс-спектрометрического анализа «АЛМАСС Био» по
ТУ 26.60.12-008-57564538-2022»



Рисунок 1 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 200» (вид спереди)



Рисунок 2 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 200» (вид справа)



Рисунок 3 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 200» (вид слева)

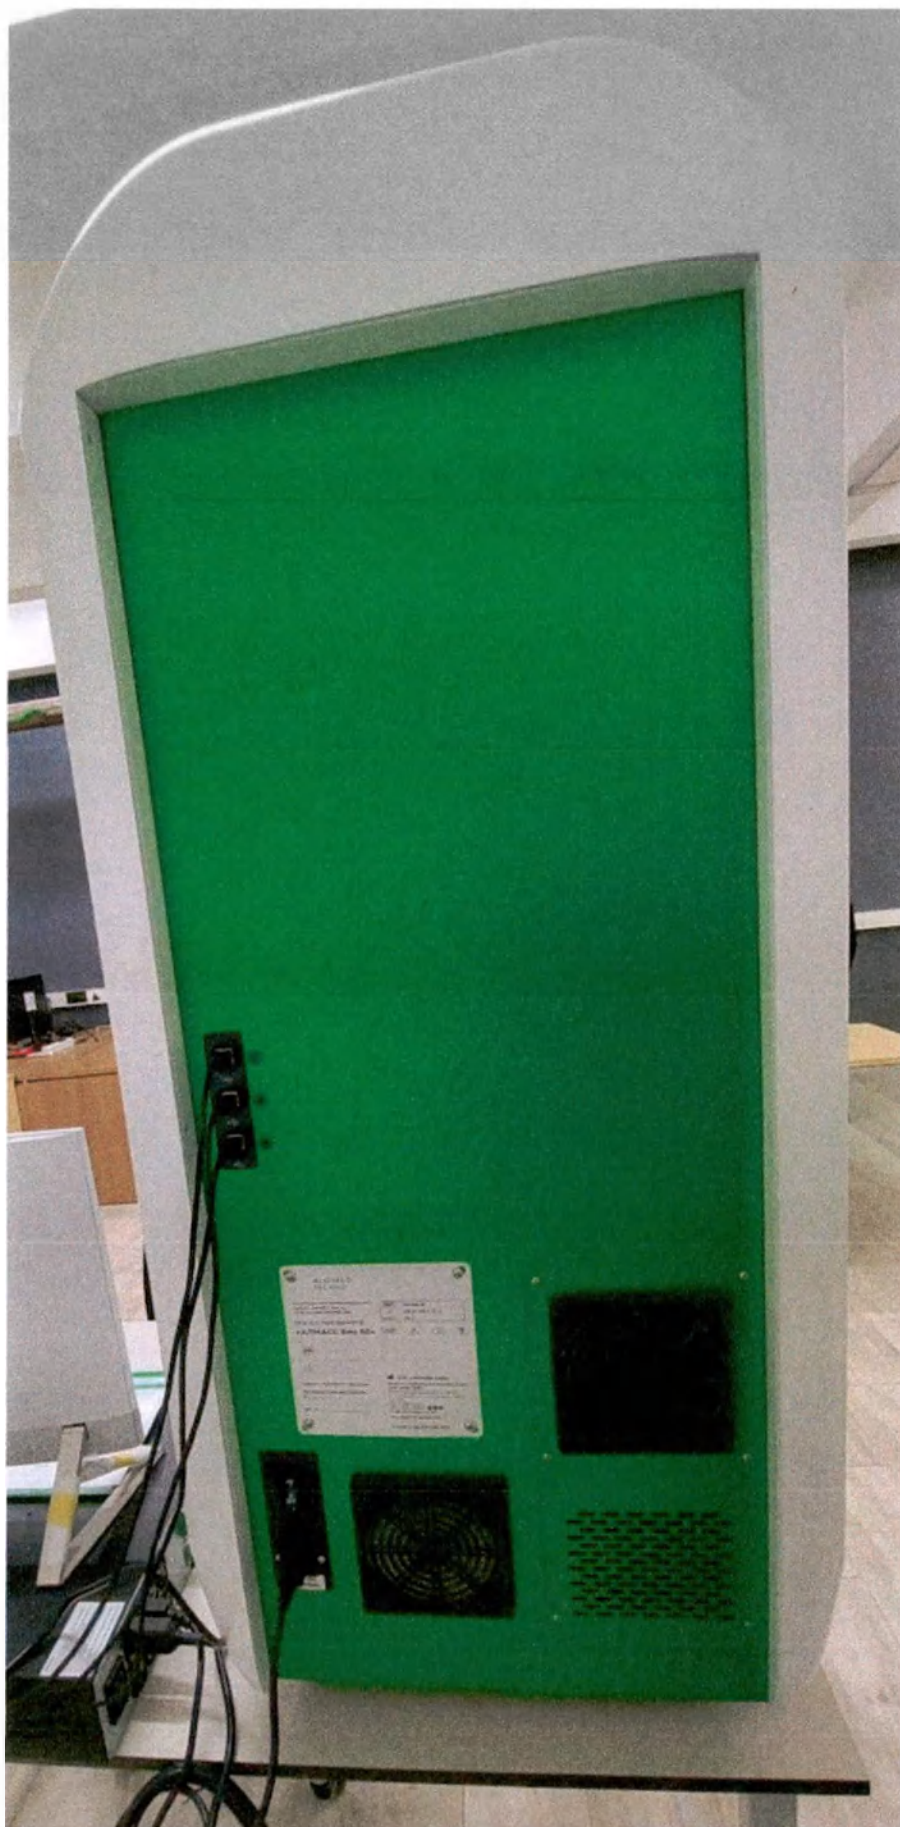


Рисунок 4 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 200» (вид слева)

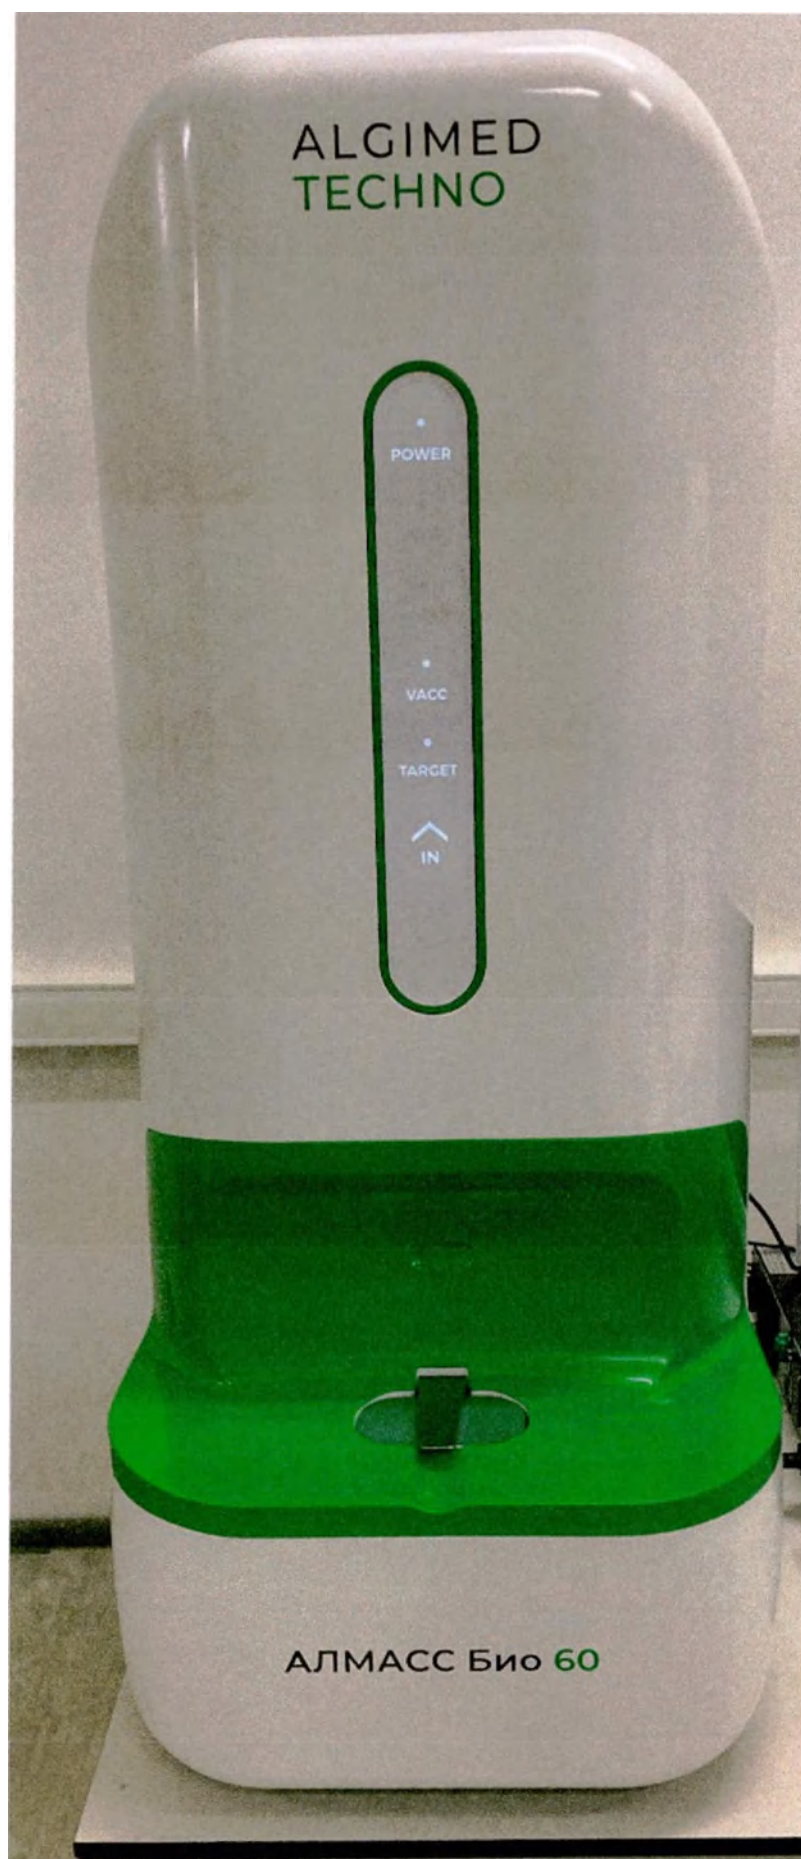


Рисунок 5 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 60»



Рисунок 6 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 60» (вид справа)



Рисунок 7 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 60» (вид слева)

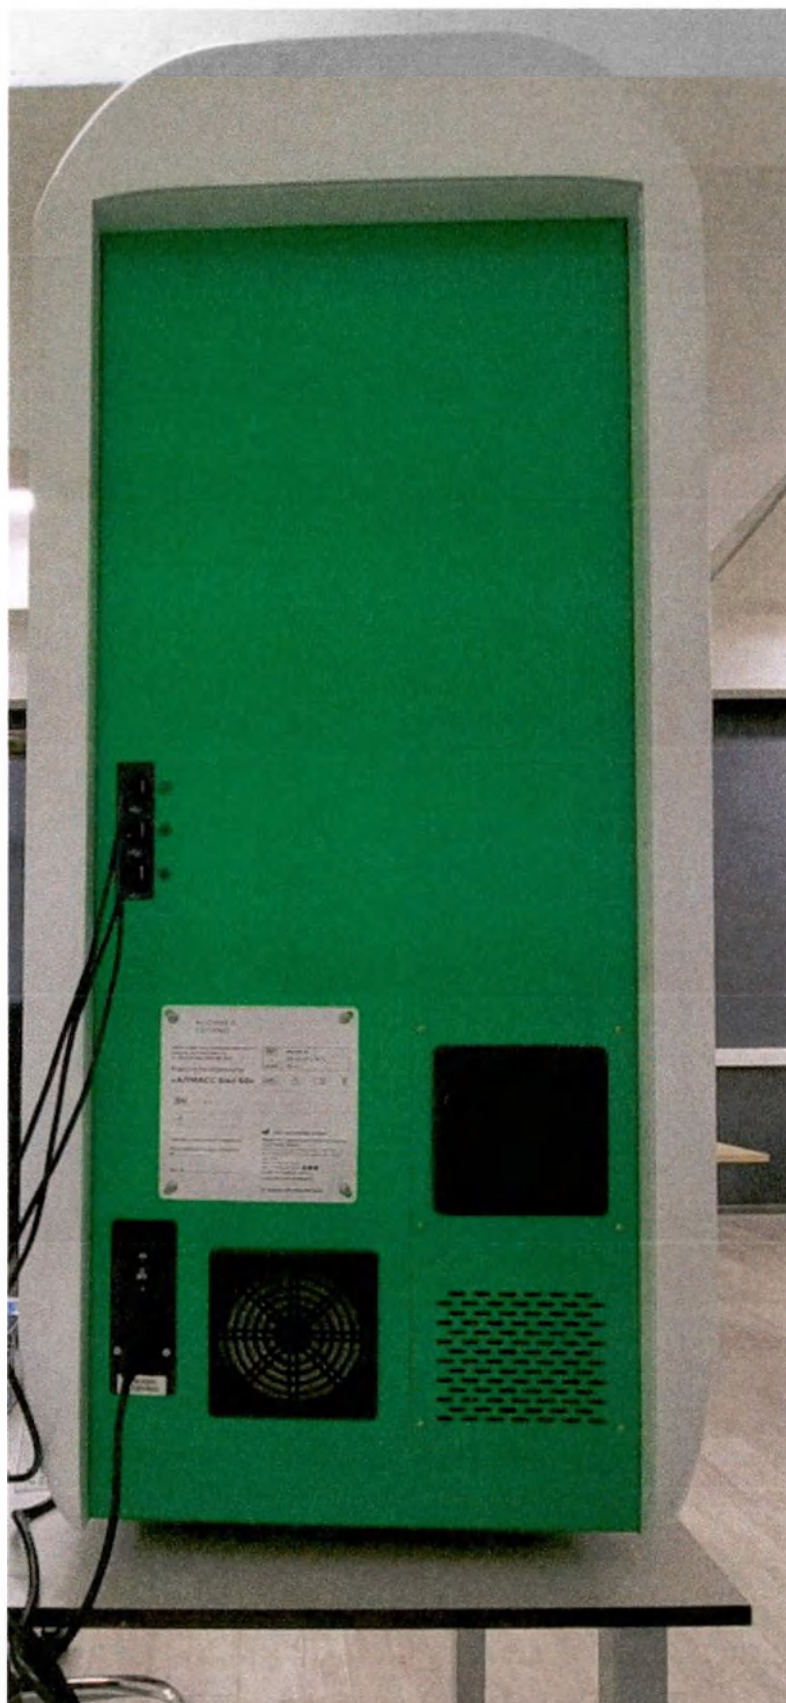


Рисунок 8 Масс-спектрометр «АЛМАСС Био 60» (вид сзади)



Рисунок 9 Кабель питания к масс-спектрометру;

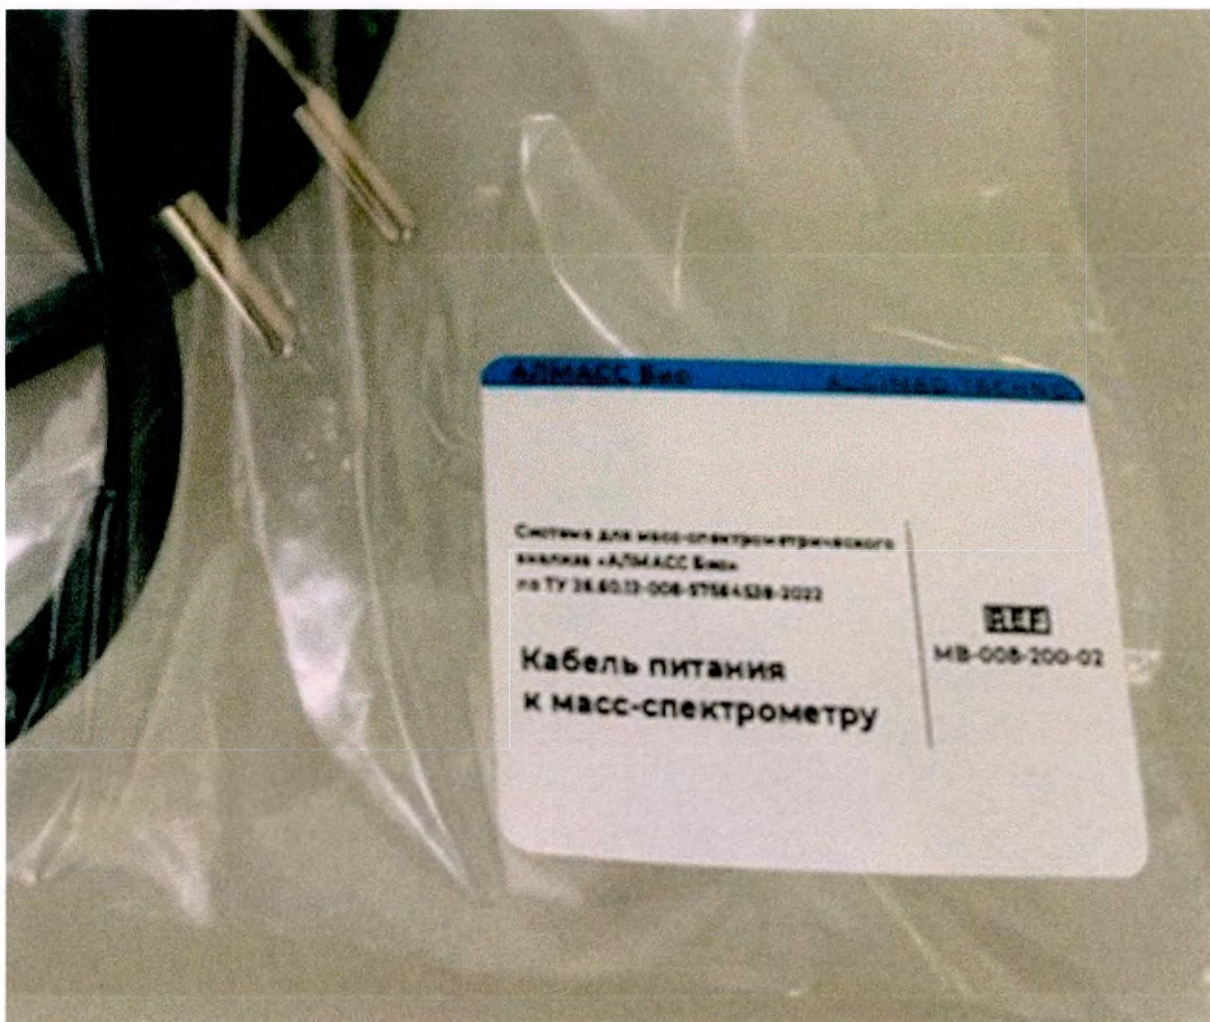


Рисунок 9а Кабель питания к масс-спектрометру (маркировка);



Рисунок 10 Рабочая станция, в составе:

- *Моноблок*
- *Компьютерная мышь*
- *Клавиатура*
- *Кабель питания к рабочей станции*
- *Коврик для компьютерной мыши*



Рисунок 10а Рабочая станция (моноблок) (вид сзади)

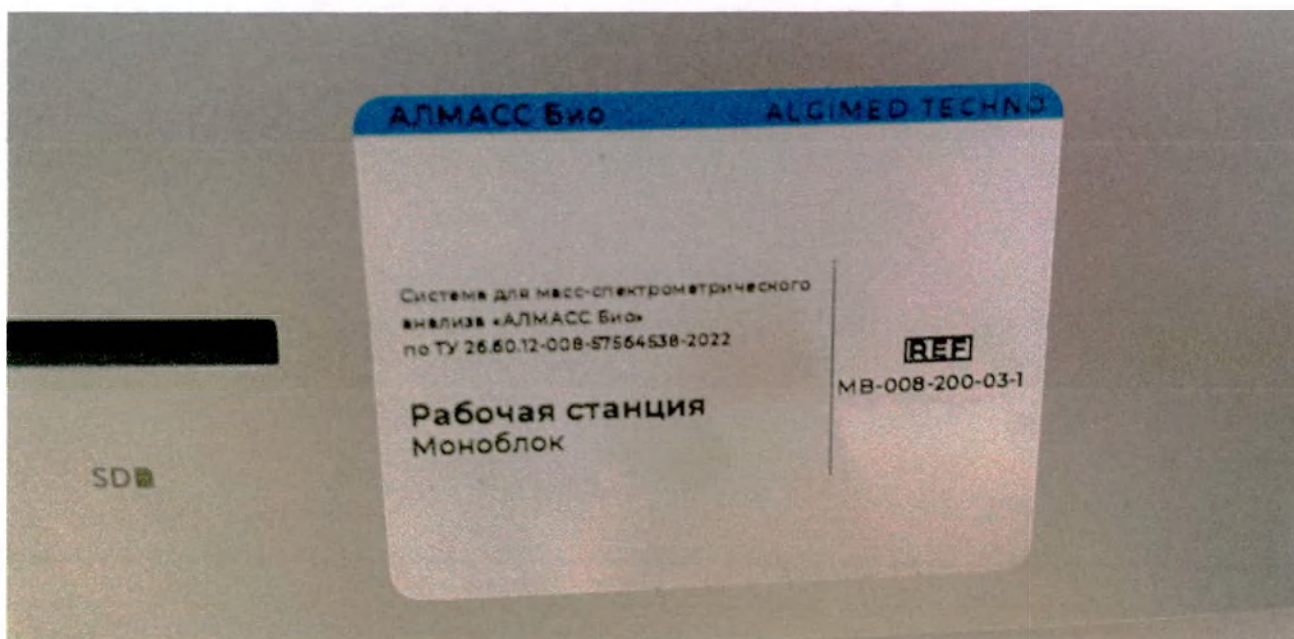


Рисунок 10б Рабочая станция (моноблок) (маркировка)



Рисунок 10в Рабочая станция (компьютерная мышь) (маркировка)

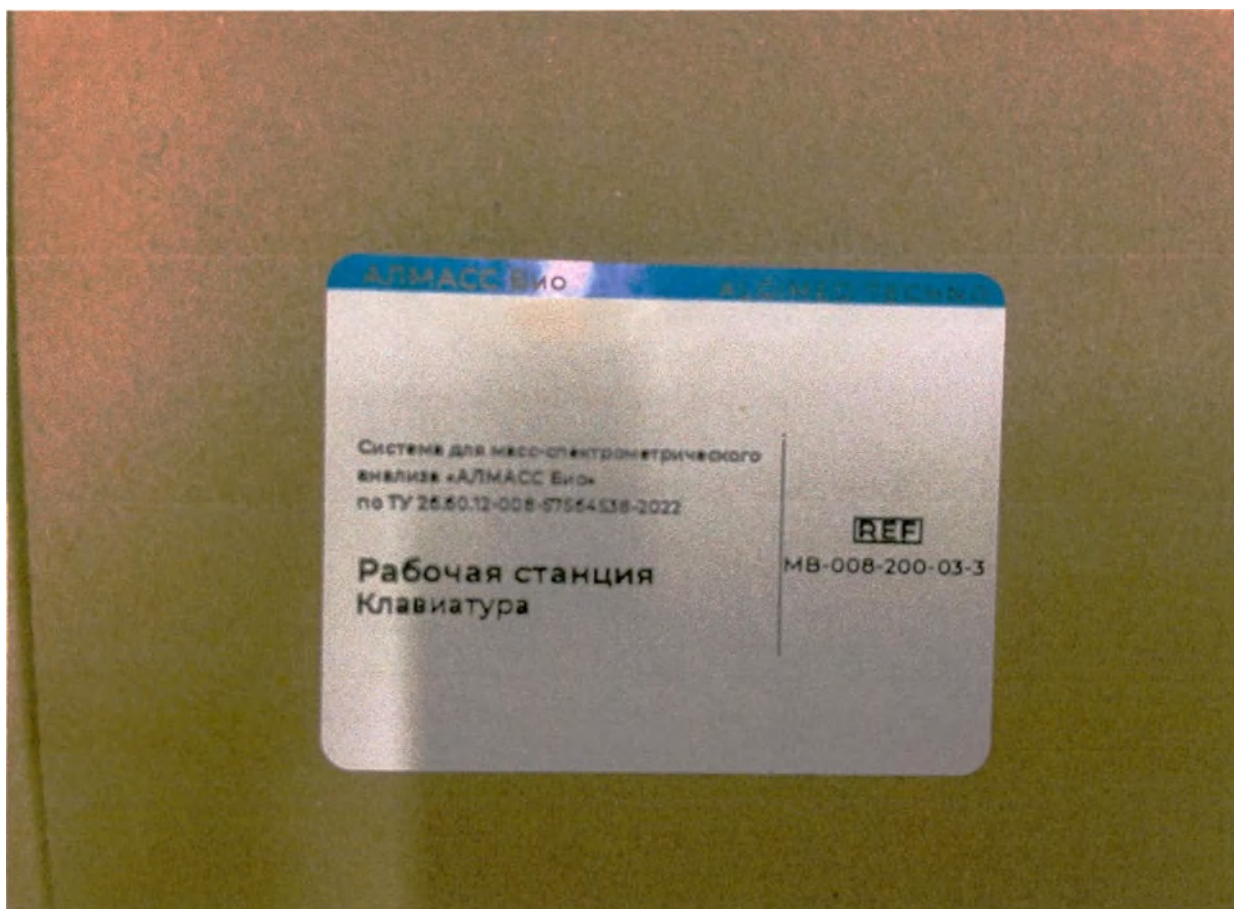


Рисунок 10г Рабочая станция (клавиатура) (маркировка)



Рисунок 10д Кабель питания к рабочей станции



Рисунок 10е Кабель питания к рабочей станции (маркировка)

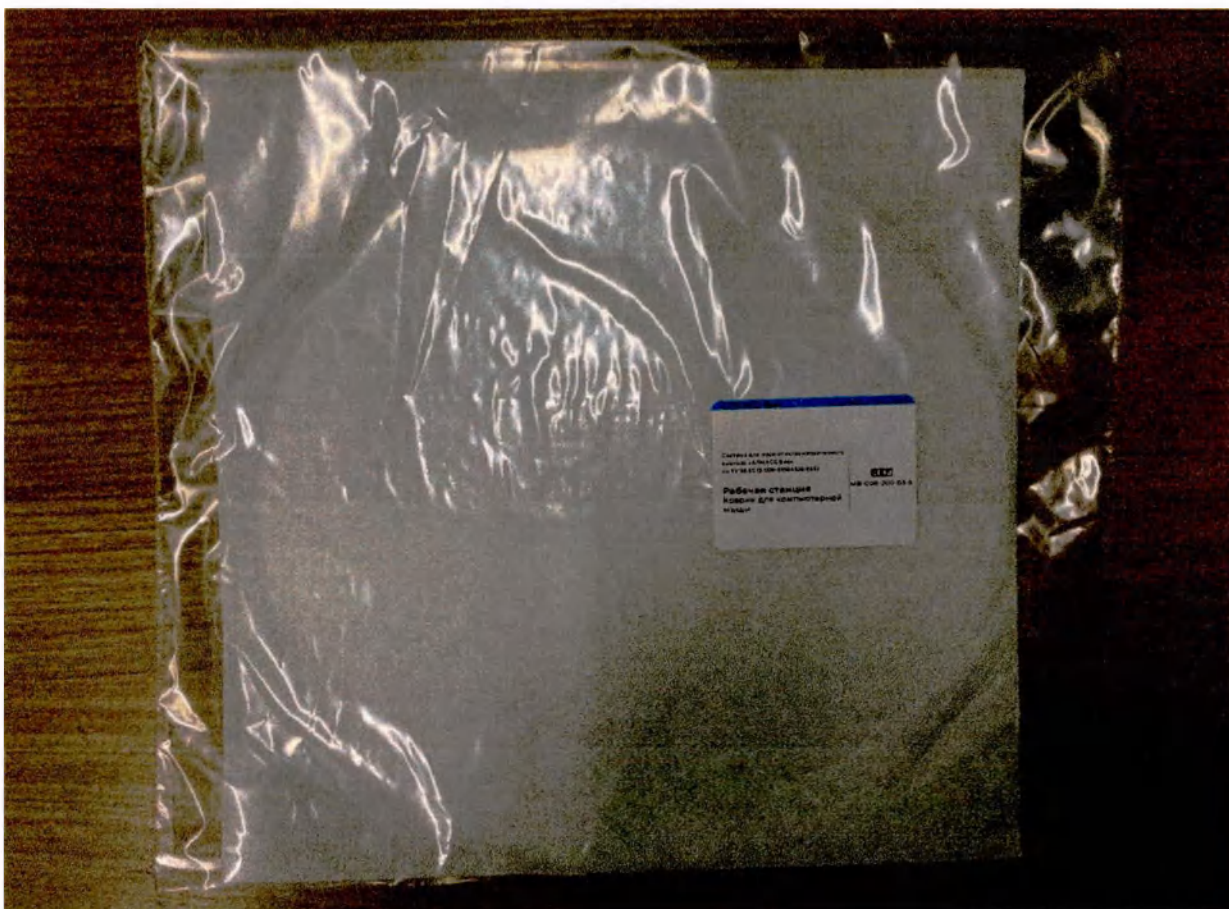


Рисунок 10ж Коврик для компьютерной мыши (маркировка)

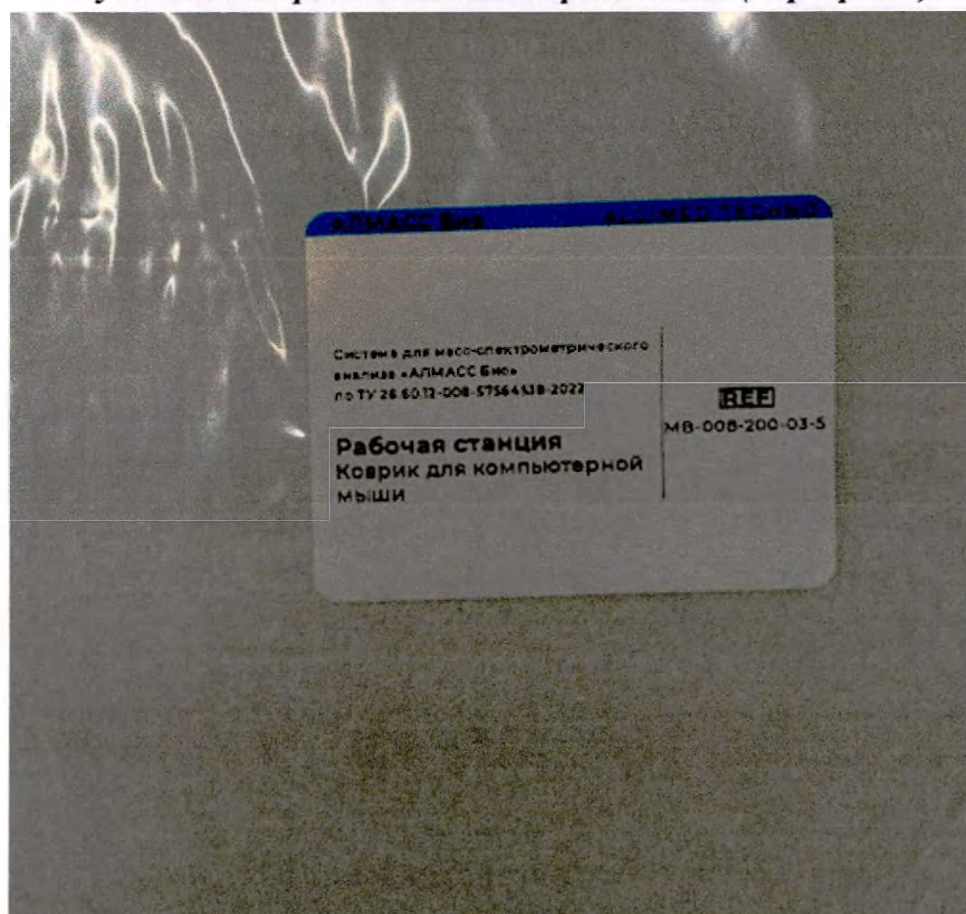


Рисунок 10з Коврик для компьютерной мыши (маркировка)

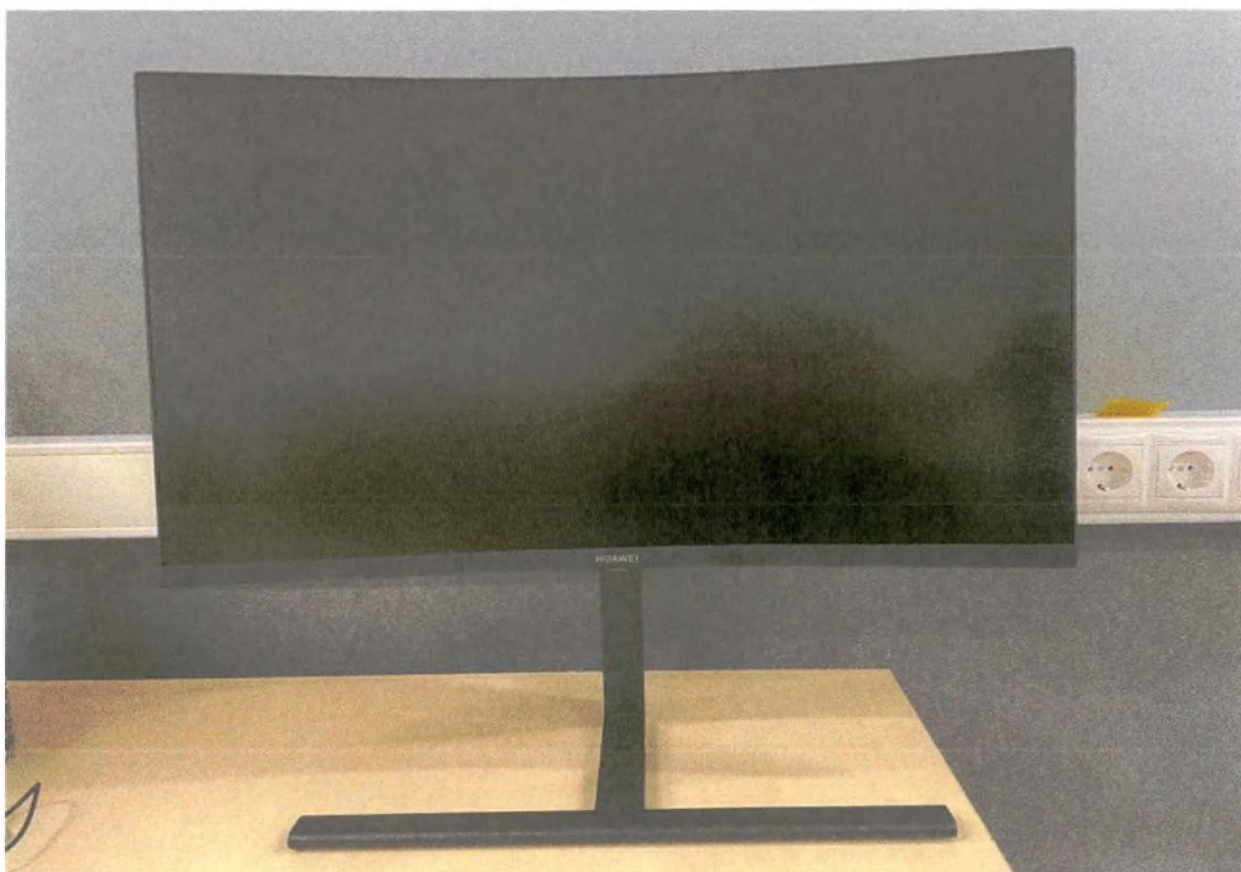


Рисунок 11 Монитор (при необходимости)

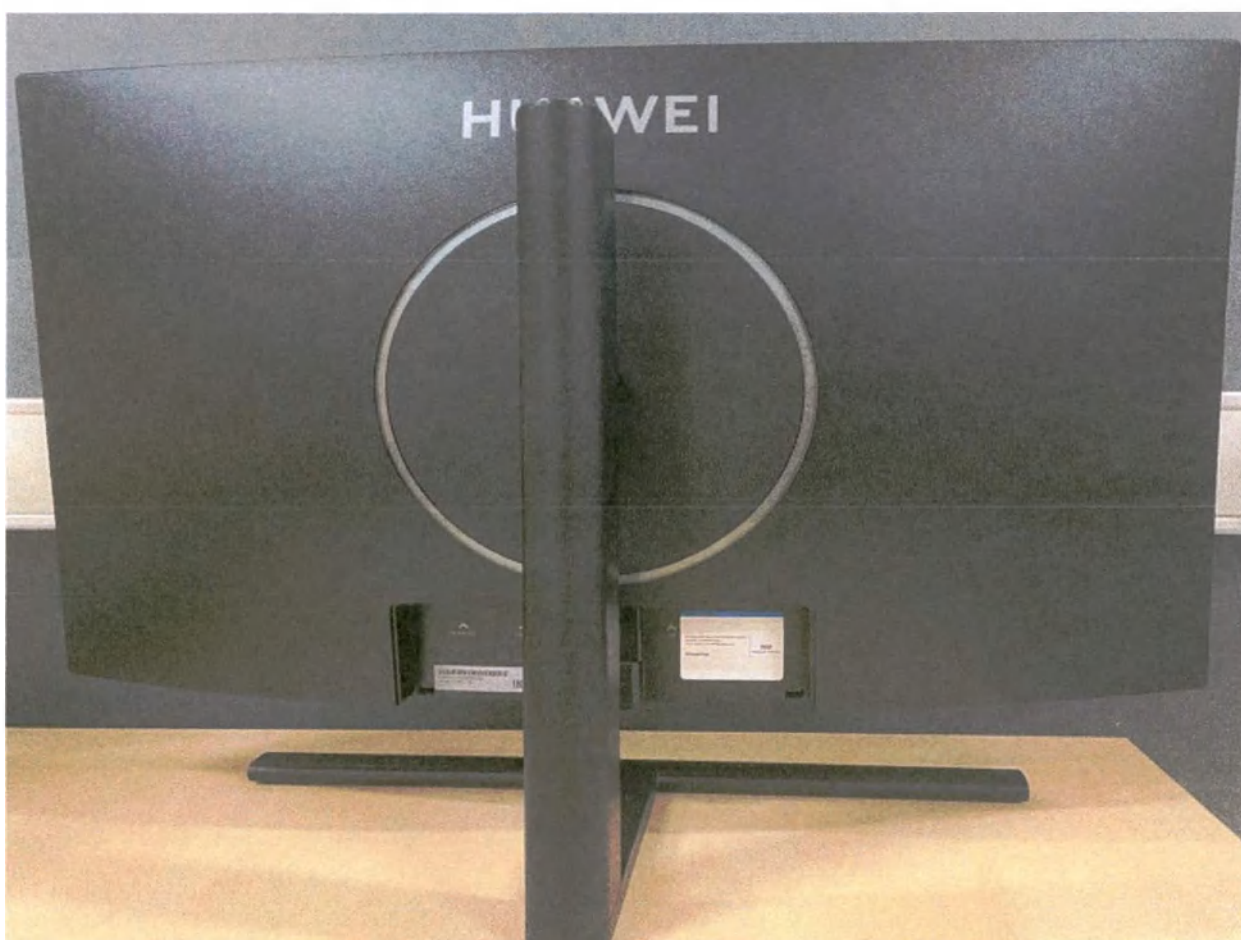


Рисунок 11а Монитор (при необходимости) (вид сзади)



Рисунок 11б Монитор (при необходимости) (маркировка)



Рисунок 12 Источник бесперебойного питания (при необходимости)



Рисунок 12а Источник бесперебойного питания (при необходимости) (вид сзади)

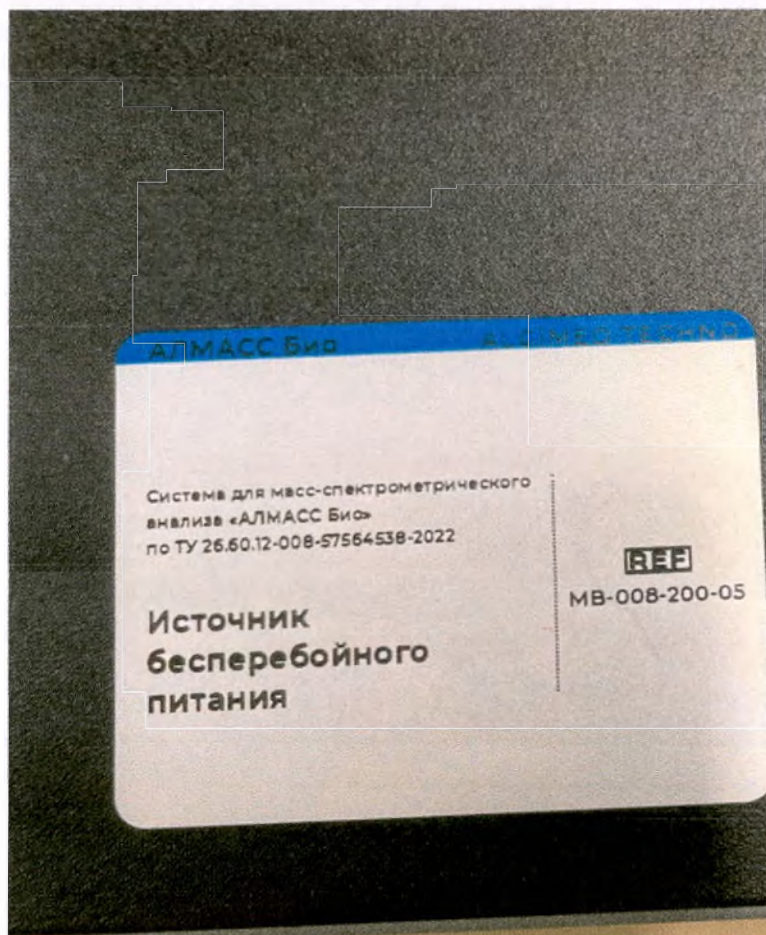


Рисунок 12б Источник бесперебойного питания (при необходимости) (маркировка)



Рисунок 13 Кабель питания рабочей станции к источнику бесперебойного питания (при необходимости)

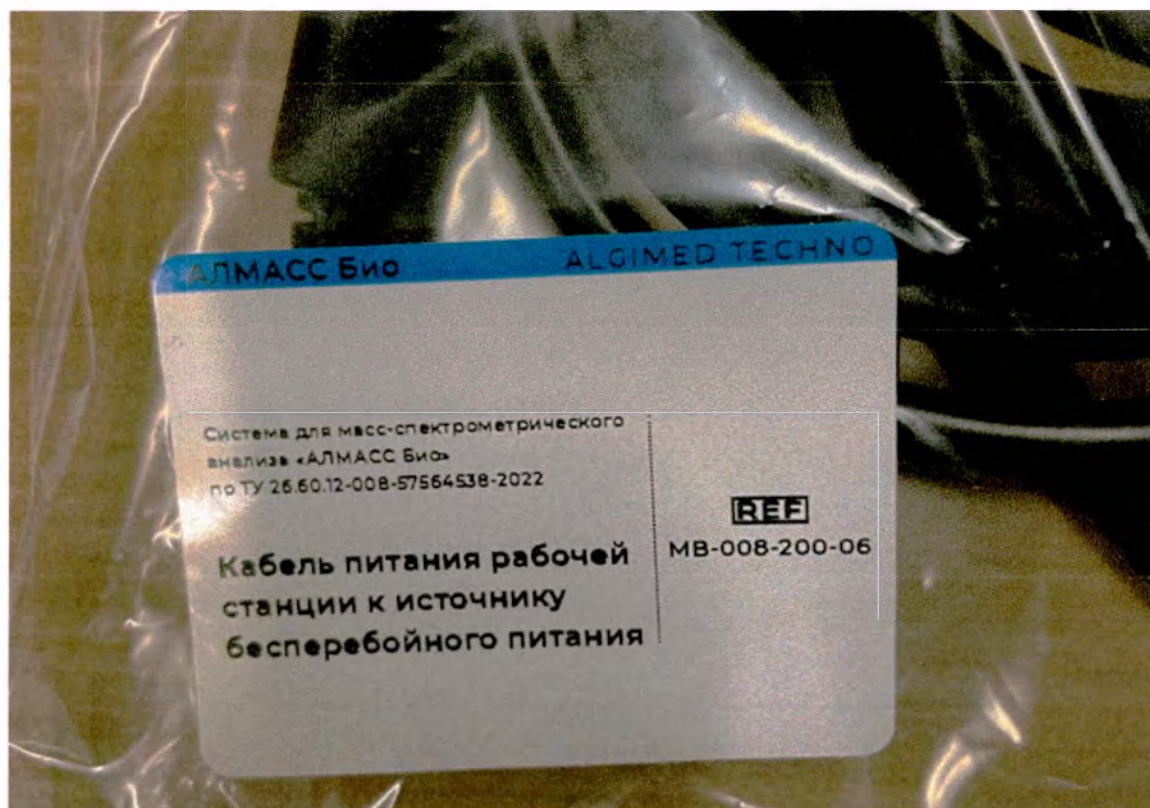


Рисунок 13а Кабель питания рабочей станции к источнику бесперебойного питания (при необходимости) (маркировка)



Рисунок 14 Кабель питания масс-спектрометра к источнику бесперебойного питания (при необходимости)

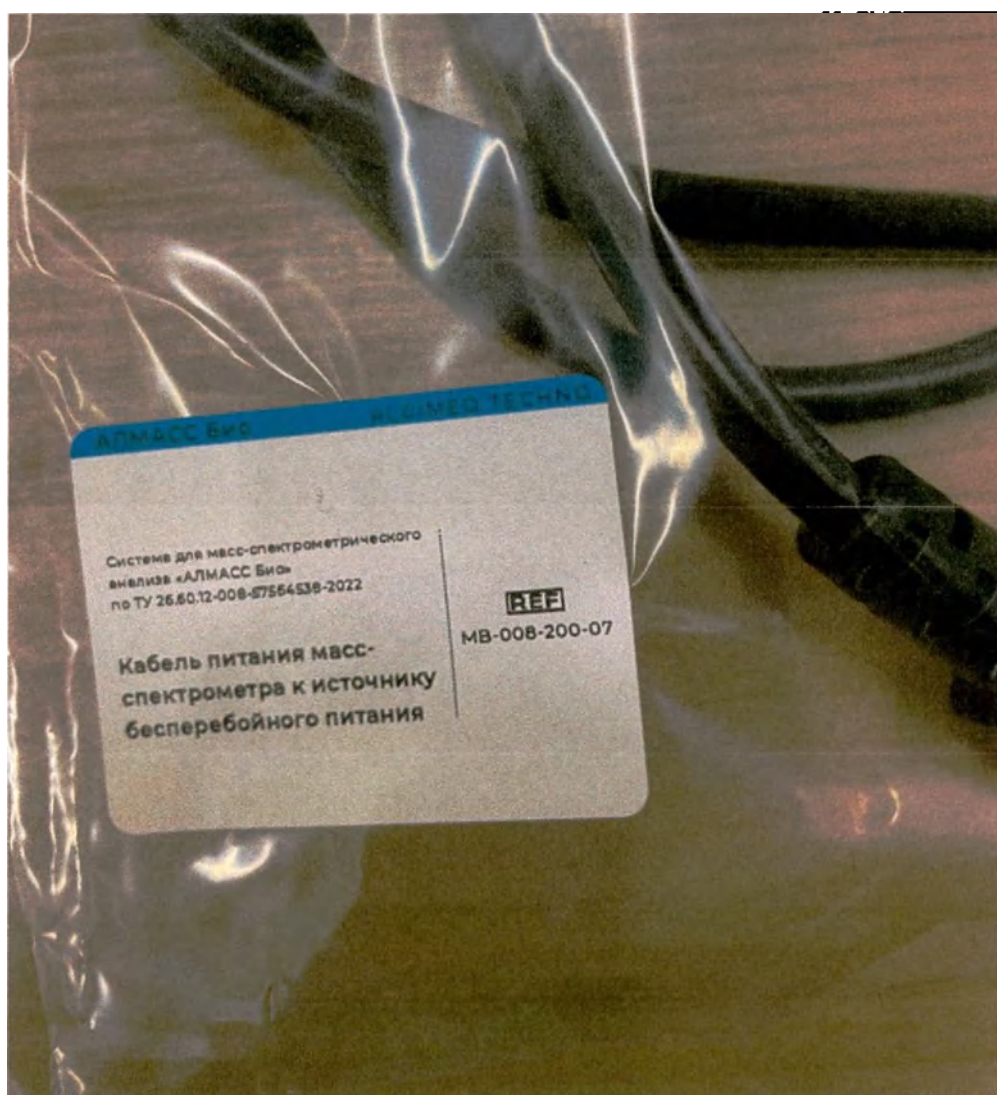


Рисунок 14а Кабель питания масс-спектрометра к источнику бесперебойного питания (при необходимости) (вид маркировки)

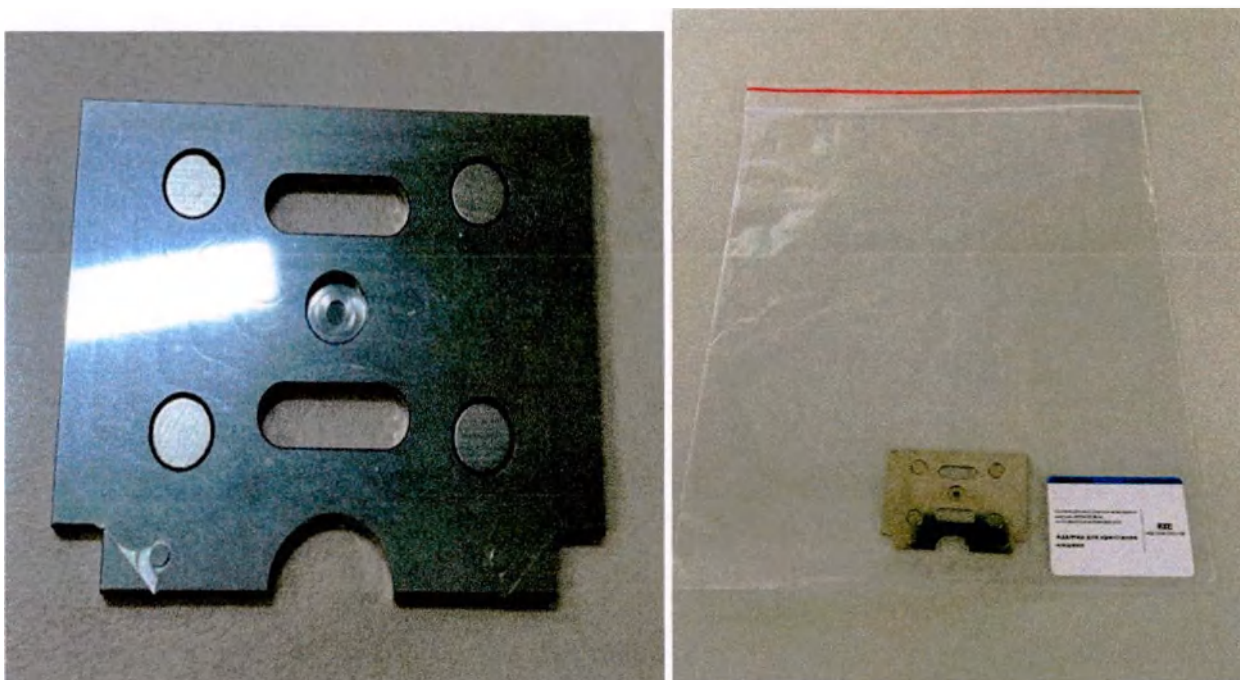


Рисунок 15 Адаптер для крепления мишени



Рисунок 15а Адаптер для крепления мишени (маркировка)



Рисунок 16 USB кабель



Рисунок 16а USB кабель (вид маркировки)



Рисунок 17 Стилус для нанесения образцов (при необходимости)



Рисунок 17а Стилус для нанесения образцов (при необходимости) (маркировка)

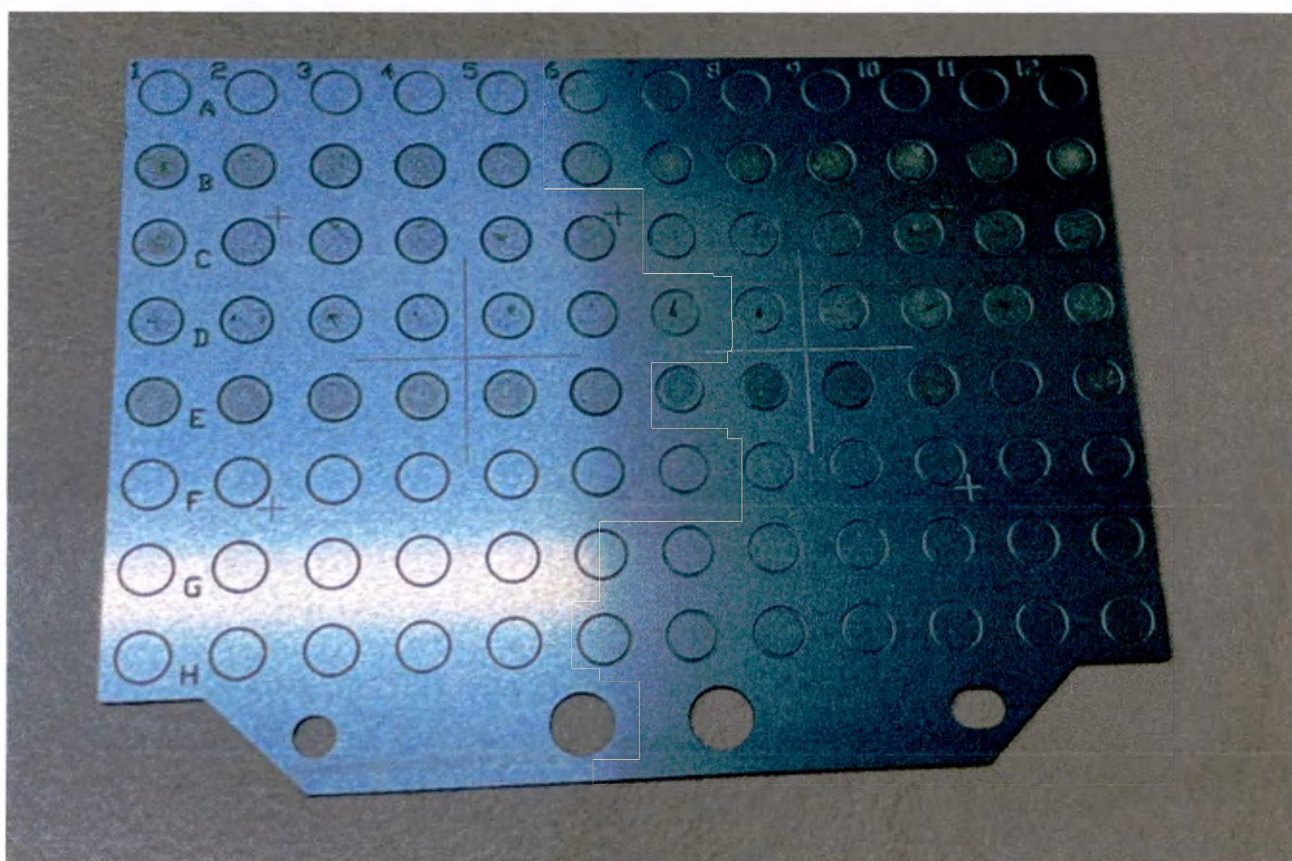


Рисунок 18 Мишень многоразовая стальная на 96 точек

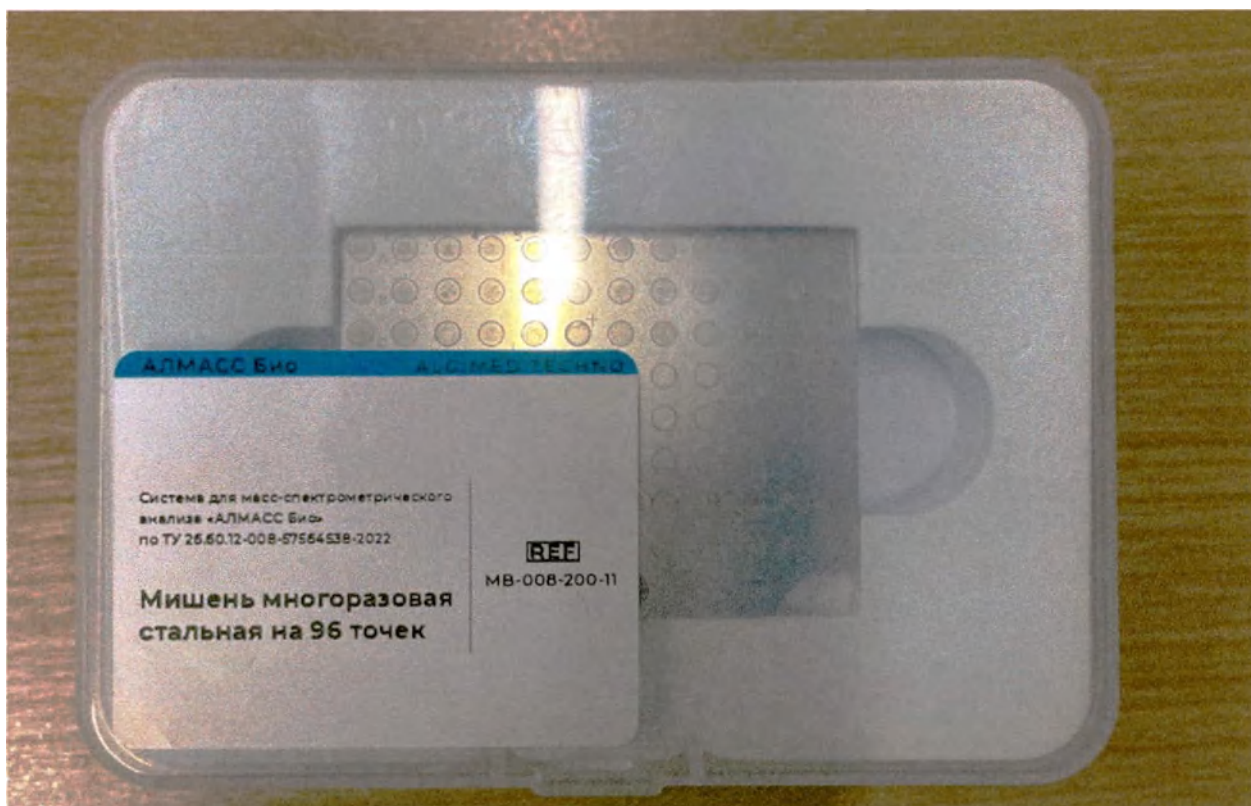


Рисунок 18а Мишень многоразовая стальная на 96 точек (маркировка)



Рисунок 19 Наконечники для стилуса (96 шт./уп.) (при необходимости) (вид одного наконечника)

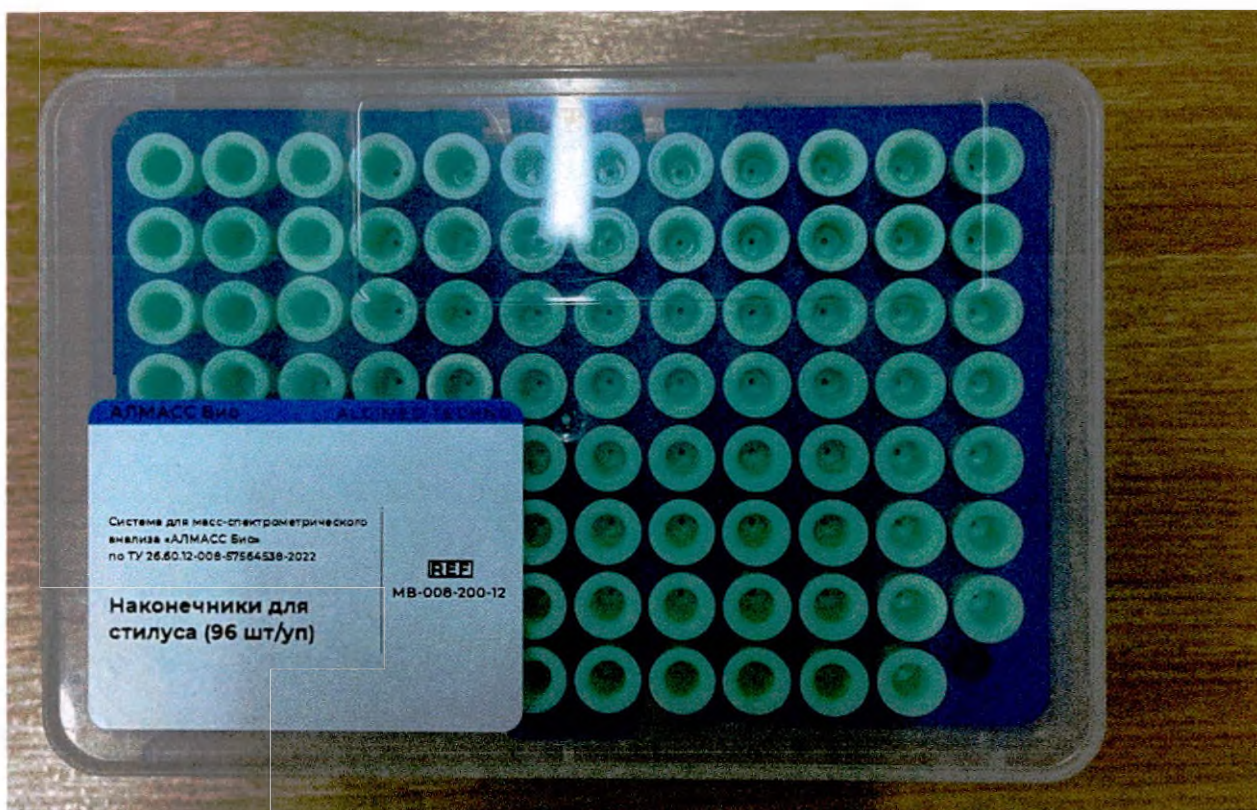


Рисунок 19а Наконечники для стилуса (96 шт./уп.) (при необходимости) (вид маркировки)



Рисунок 20 Держатель с подсветкой для нанесения образцов на мишень (при необходимости)

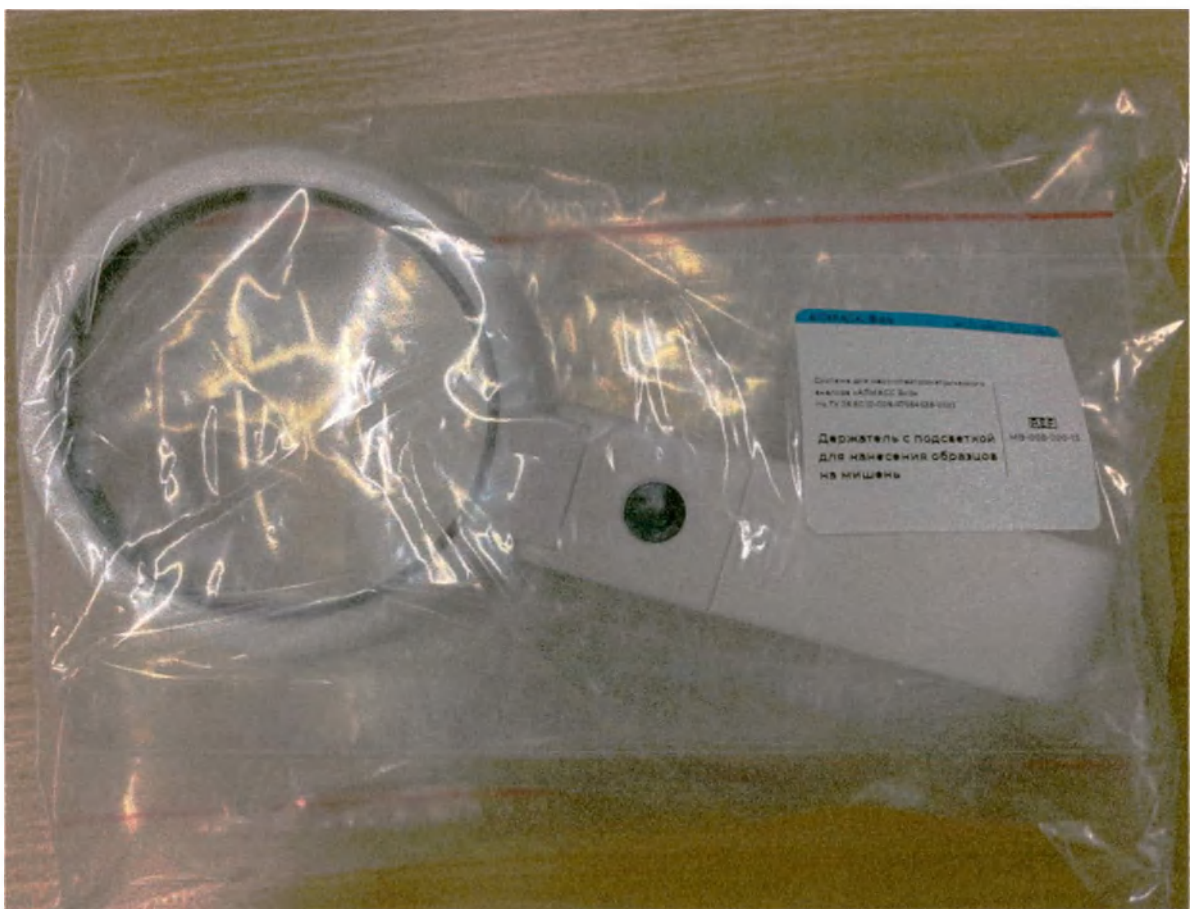


Рисунок 20а Держатель с подсветкой для нанесения образцов на мишень (при необходимости) (маркировка)



Рисунок 21 Сканер штрих-кода (при необходимости)



Рисунок 21а Сканер штрих-кода (при необходимости) (маркировка)

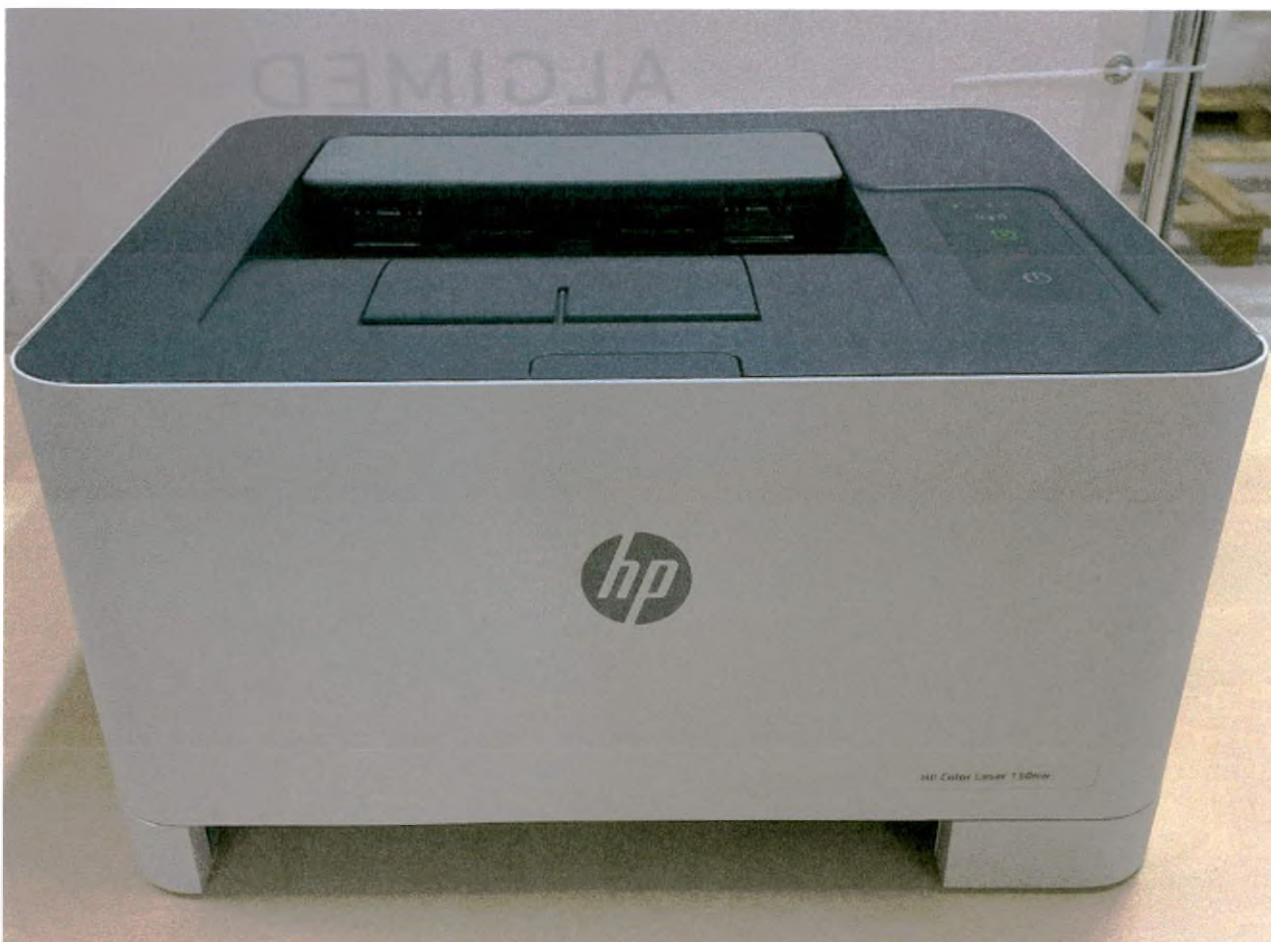


Рисунок 22 Устройство для печати (при необходимости)



Рисунок 22а Устройство для печати (при необходимости) (вид сзади)

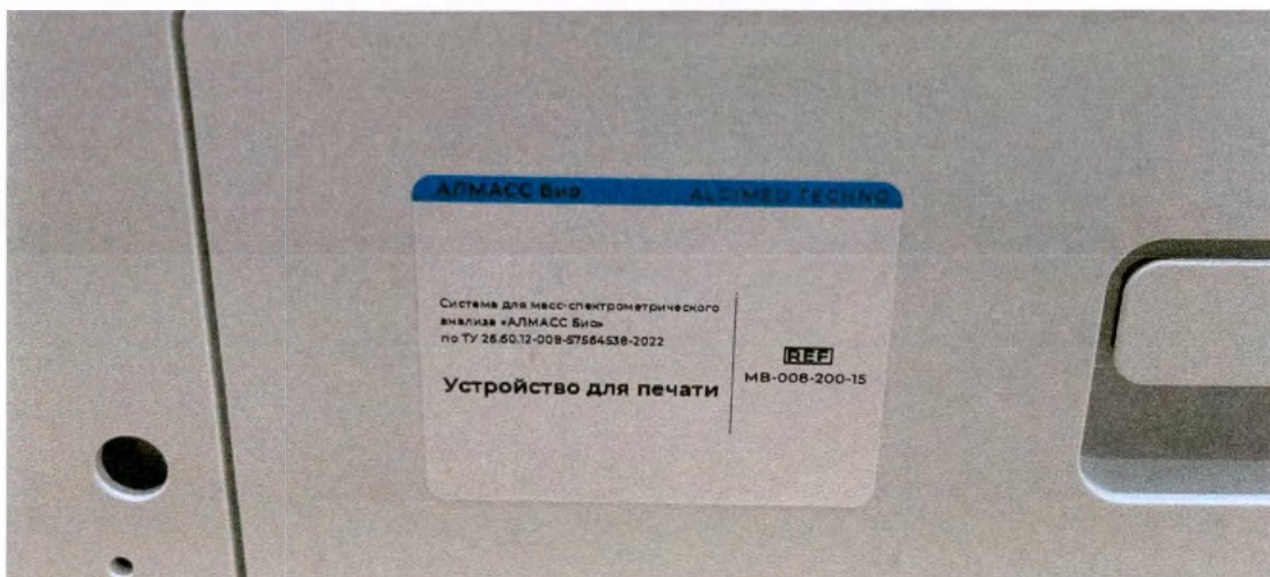


Рисунок 22б Устройство для печати (при необходимости) (маркировка)



Рисунок 23 Стол для масс-спектрометра «АЛМАСС -СП120», ТУ 31.09.13-025-57564538-2023 (при необходимости) (общий вид)



Рисунок 23а Стол для масс-спектрометра «АЛМАСС -СП120», ТУ 31.09.13-025-57564538-2023 (при необходимости) (в транспортной упаковке)



*Рисунок 24 Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023
(флаконы без упаковки)*



Рисунок 24а Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 3К»



Рисунок 246 Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био 9К»



Рисунок 24в Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Стандарт»



Рисунок 24г Набор реагентов «АЛМАСС Био» по ТУ 21.20.23-021-57564538-2023, вариант исполнения: «АЛМАСС Био Матрица»



Рисунок 25 Общий вид системы для масс-спектрометрического анализа «АЛМАСС Био» по ТУ 26.60.12-008-57564538-2022

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

38 тридцать восемь) листов

Исполнительный директор ООО «Альгимед Техно»

Ластовская В.Н.

«27» сентября 2024 года М.П.

