


Фотографическое изображение общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу парагриппа 2 типа» «ИФА -
Парагрипп 2- IgG» с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

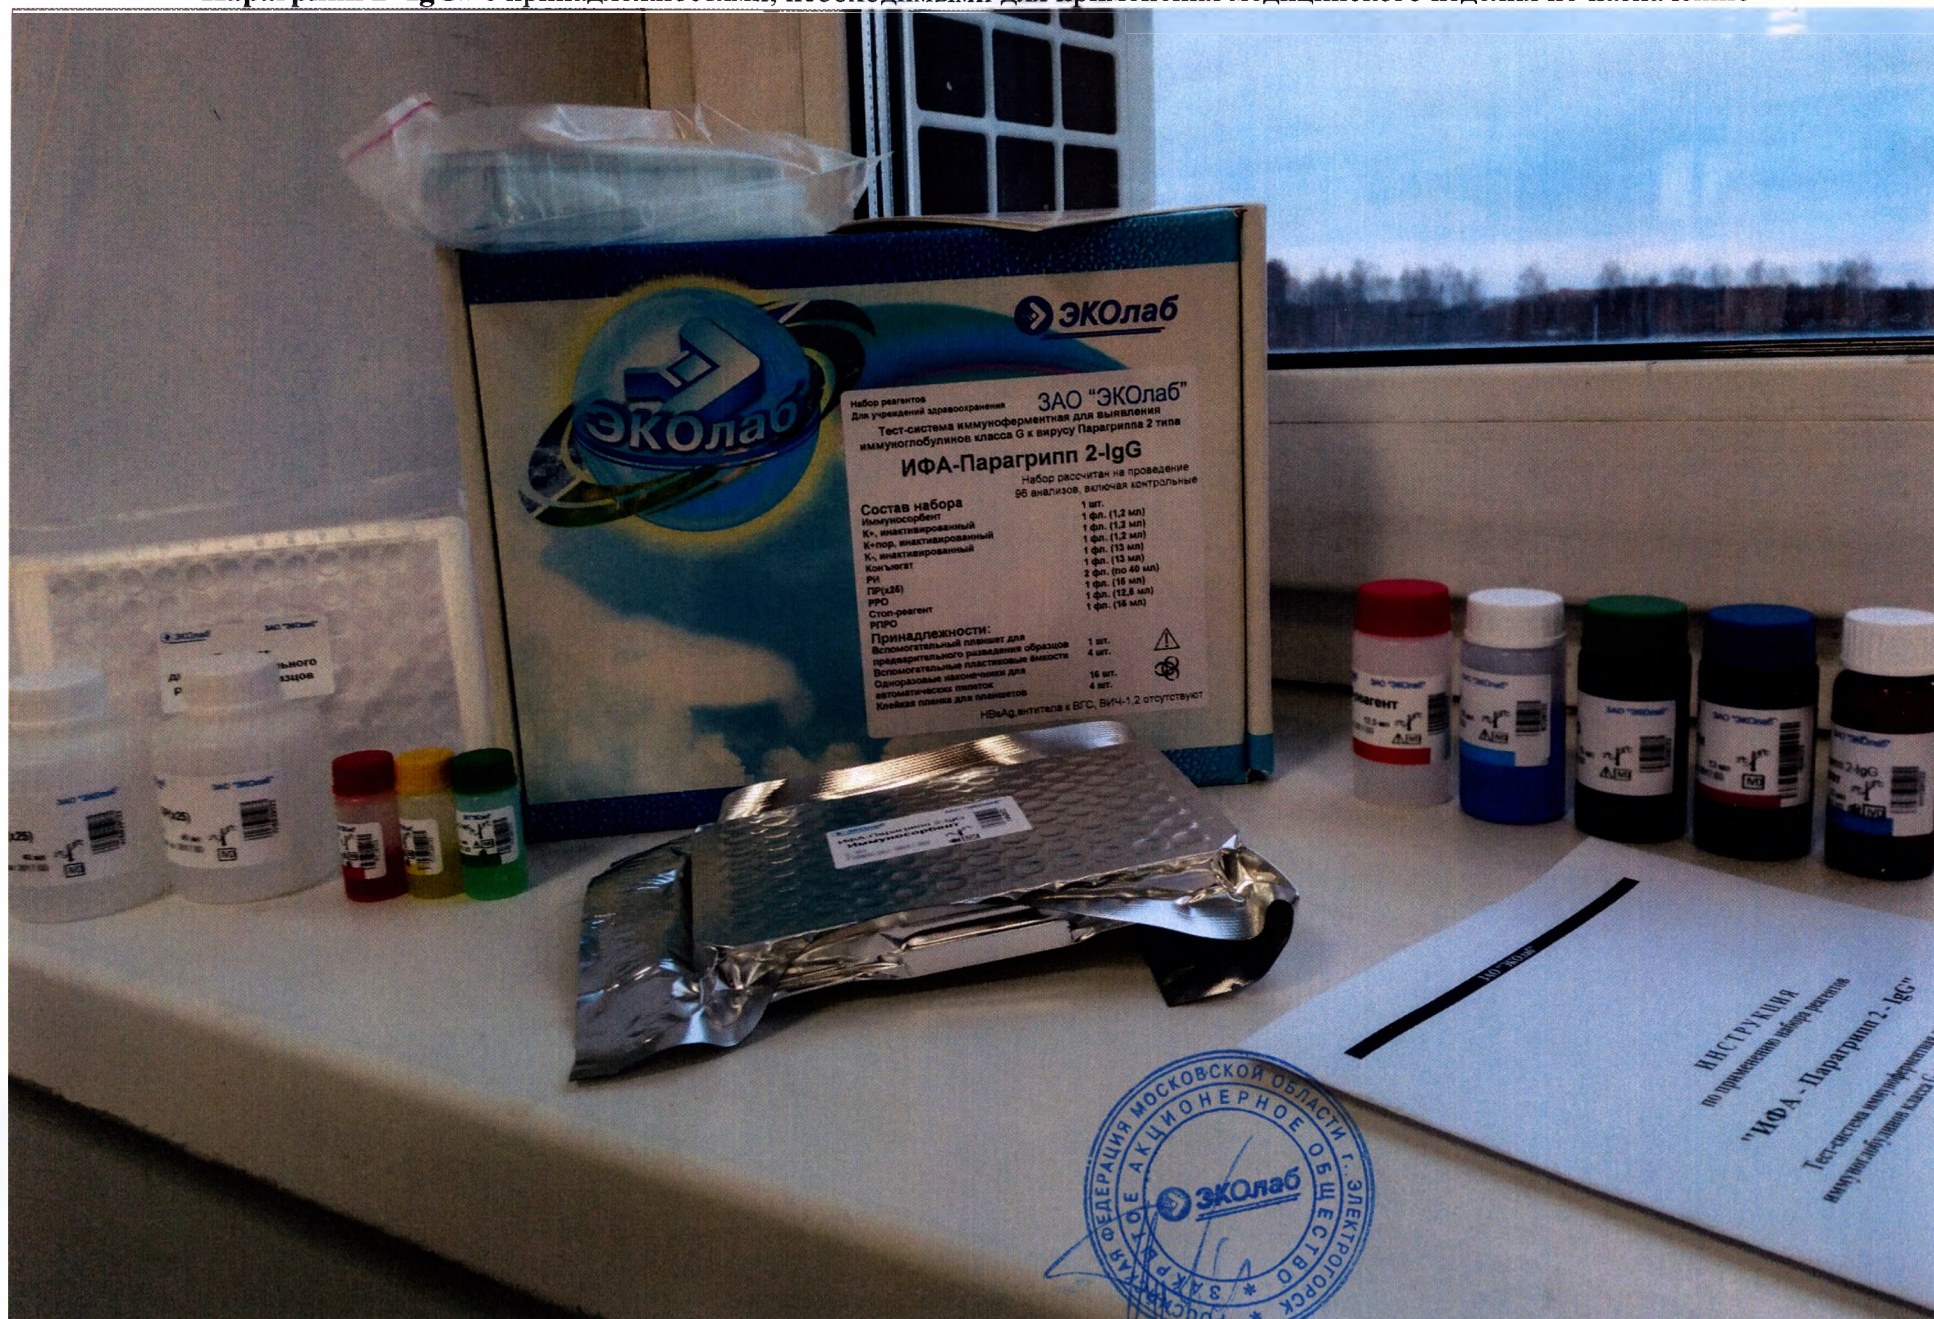

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
20 17 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу Парагриппа 2 типа

ИФА-Парагрипп 2-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К+пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ПР(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РРО	1 фл. (16 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
РПРО	1 фл. (16 мл)

Принадлежности:

Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Парагрипп 2-IgG

ТУ 9398-165-70423725-2016

РУ №

Каталожный № 29.02.2


Серия 02 Контрольный № 71

Дата изготовления: 2016.02

Голен до: 2017.03



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

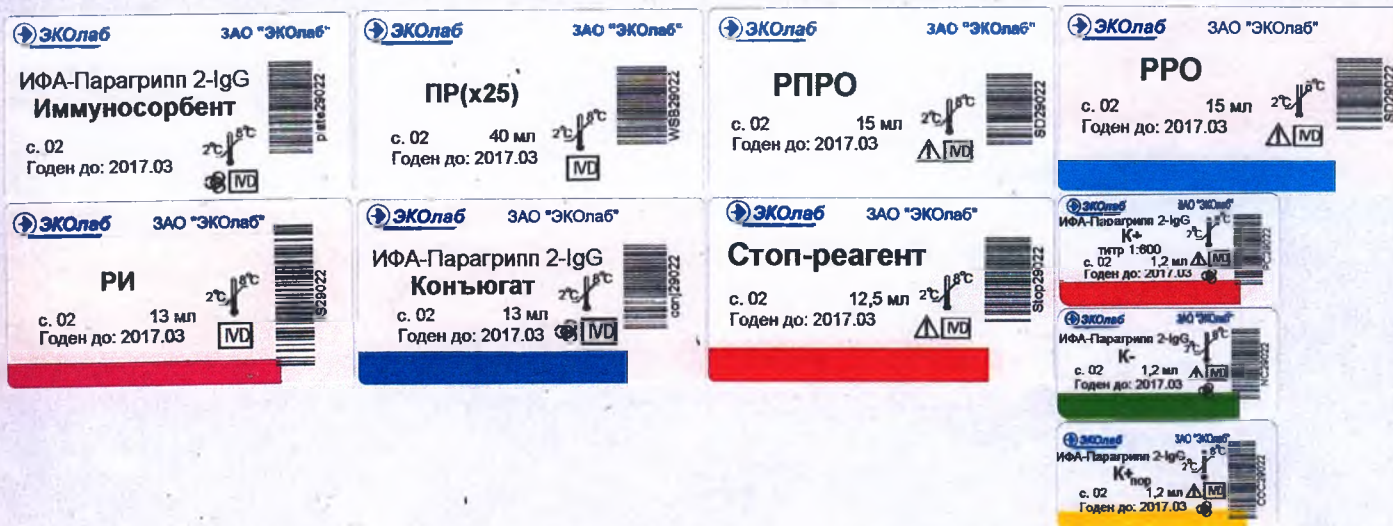

Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.