


набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления специфических иммуноглобулинов класса М к вирусу ветряной оспы» "ИФА - ветряная оспа - IgM" с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.



Серия 01 от 07.2016 г.



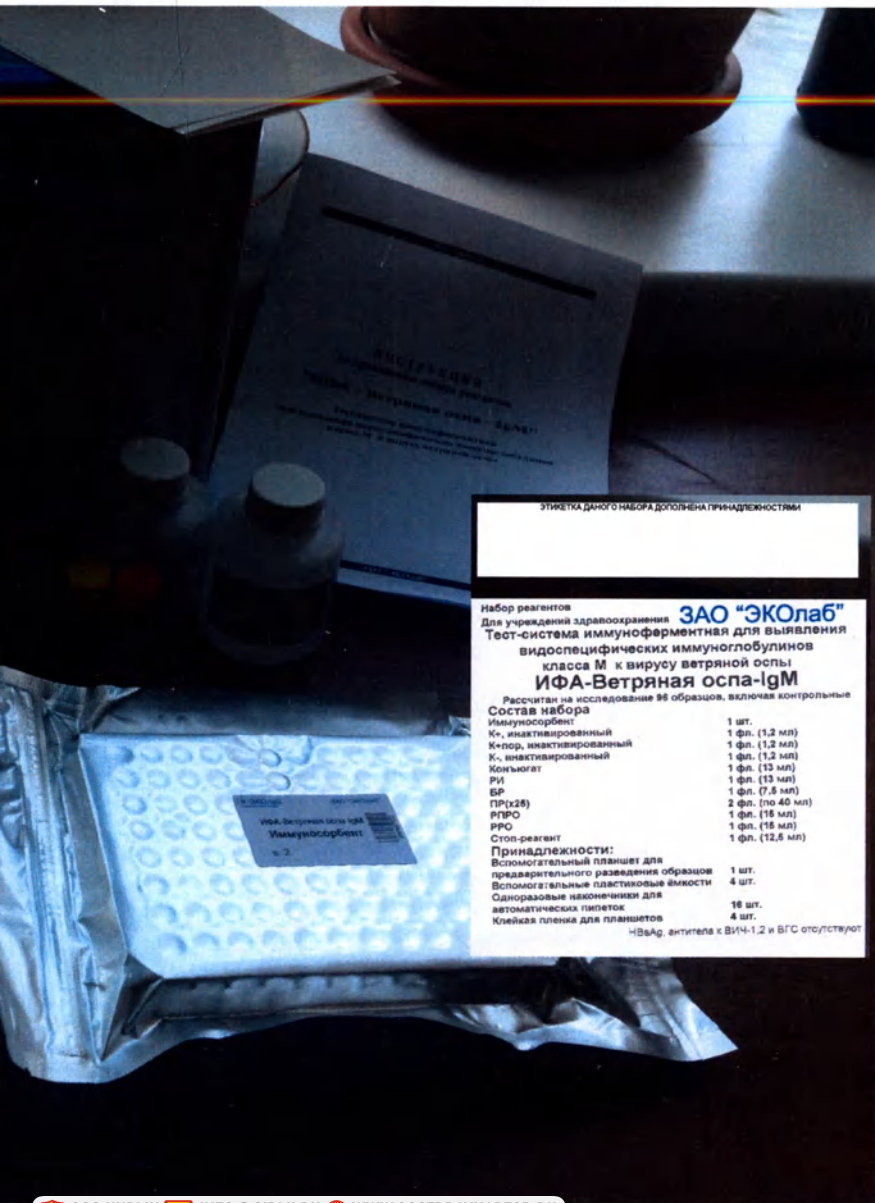

ЭТИКЕТКА ДАННОГО НАБОРА ДОПОЛНЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Набор реагентов
 Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**
Тест-система иммуноферментная для выявления
видоспецифических иммуноглобулинов
класса М к вирусу ветряной оспы
ИФА-Ветряная оспа-IgM

Расчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные
Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К-пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
БР	1 фл. (7,6 мл)
ПР(128)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (16 мл)
РРО	1 фл. (16 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,6 мл)

Принадлежности:
 Всомогательный планшет для
 предварительного разведения образцов 1 шт.
 Всомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
 Одноразовые наконечники для
 автоматических пипеток 16 шт.
 Клейкая пленка для планшетов 4 шт.

НВсАг, антитела к ВВН-1.2 и ВГС отсутствуют

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист _____
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"14" 09 2016 г.

