


Серия 01 от 2020.03



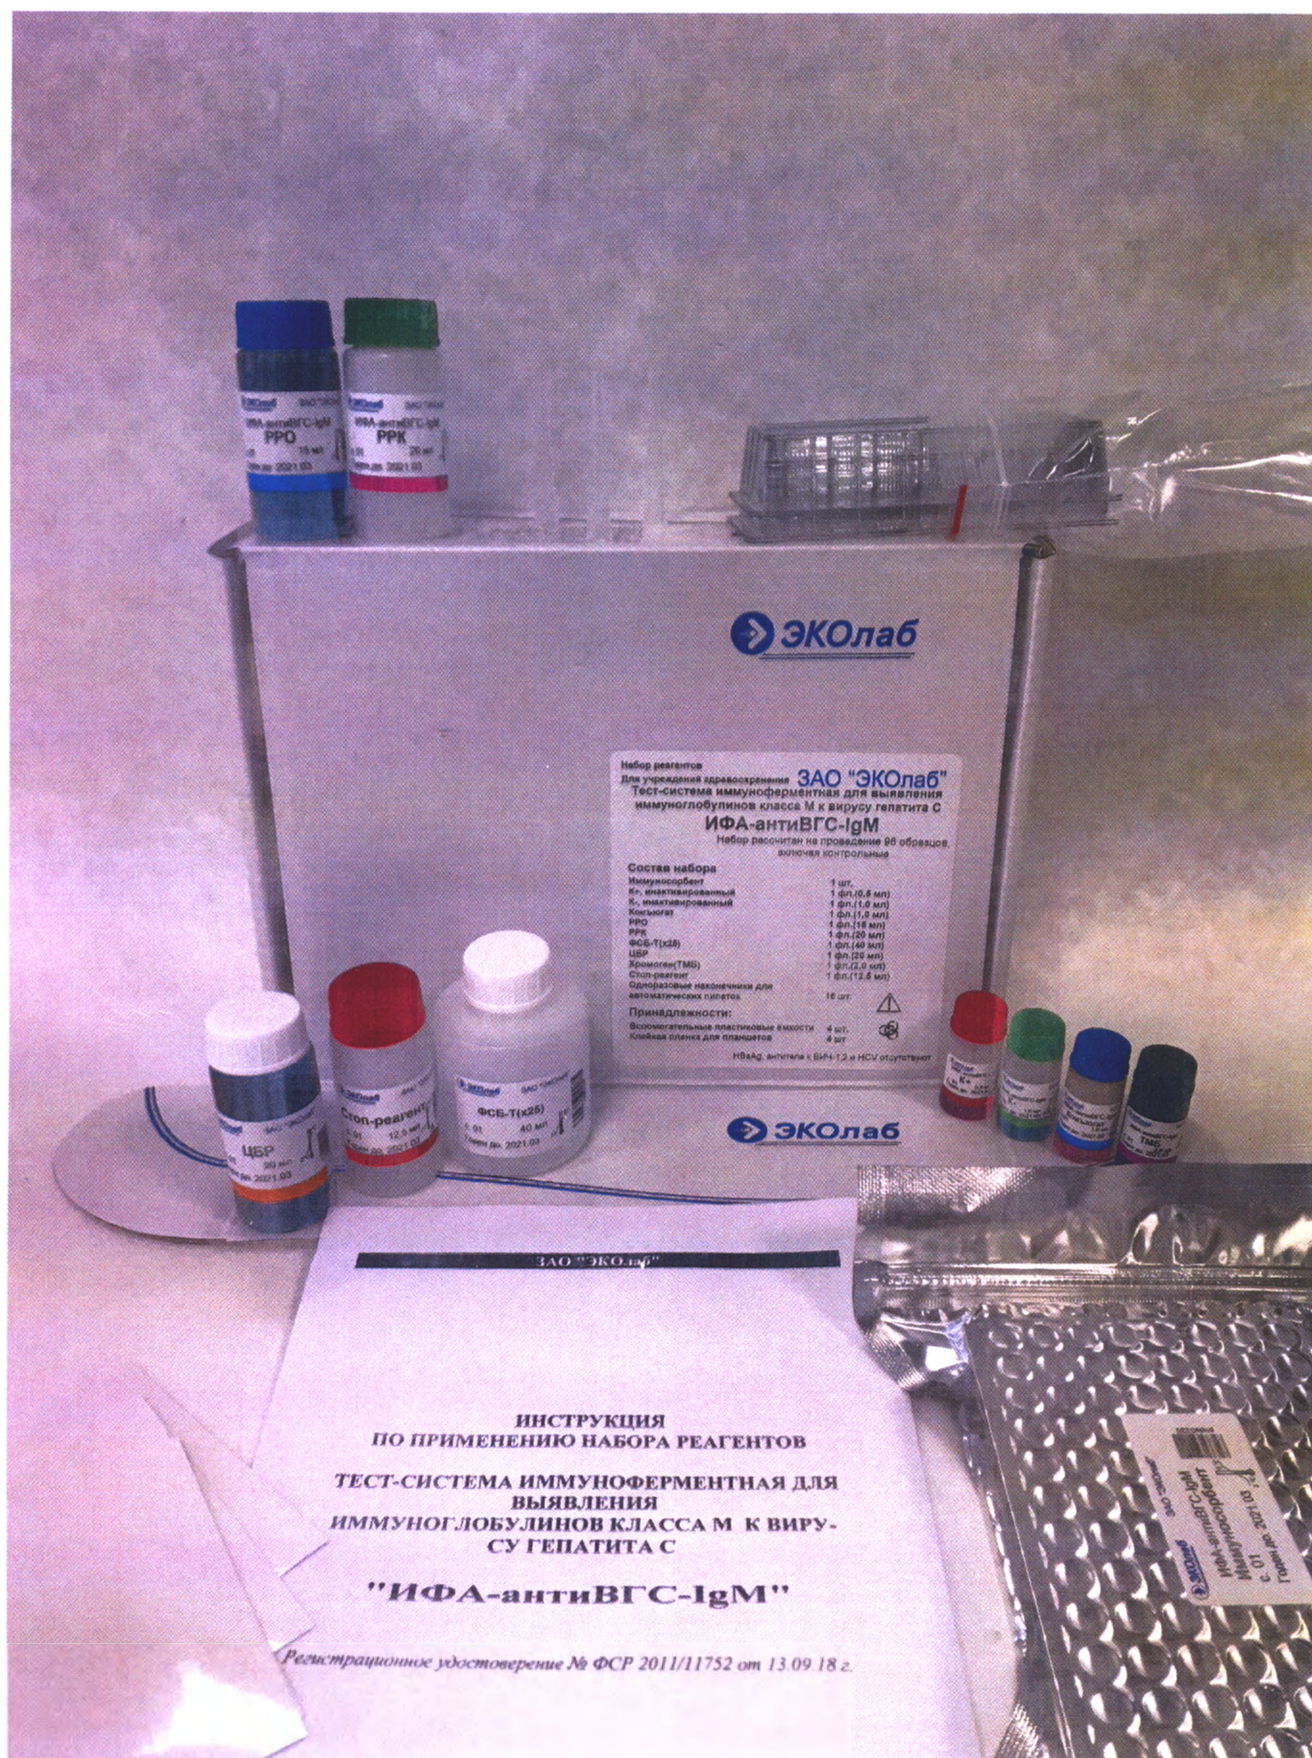

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист 2

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"14" 07 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 г



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С

ИФА-антиВГС-IgM

Набор рассчитан на проведение 96 образцов,
включая контрольные

Состав набора

Иммунсорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл.(0,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл.(1,0 мл)
Конъюгат	1 фл.(1,0 мл)
РРО	1 фл.(15 мл)
РРК	1 фл.(20 мл)
ФСБ-Т(х25)	1 фл.(40 мл)
ЦБР	1 фл.(20 мл)
Хромоген(ТМБ)	1 фл.(2,0 мл)
Стоп-реагент	1 фл.(12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и HCV отсутствуют

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

ИФА-антиВГС-IgM

ТУ 9398-127-70423725-2020

РУ №ФСР 2011/11752 от 13.09.18

Серия 01 Каталожный № 02.20
Контрольный № 168

Дата изготовления: 2020.03.27

Годеи до: 2021.03.27



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

