




Комплект №1 Серия 01 от 2020.06.



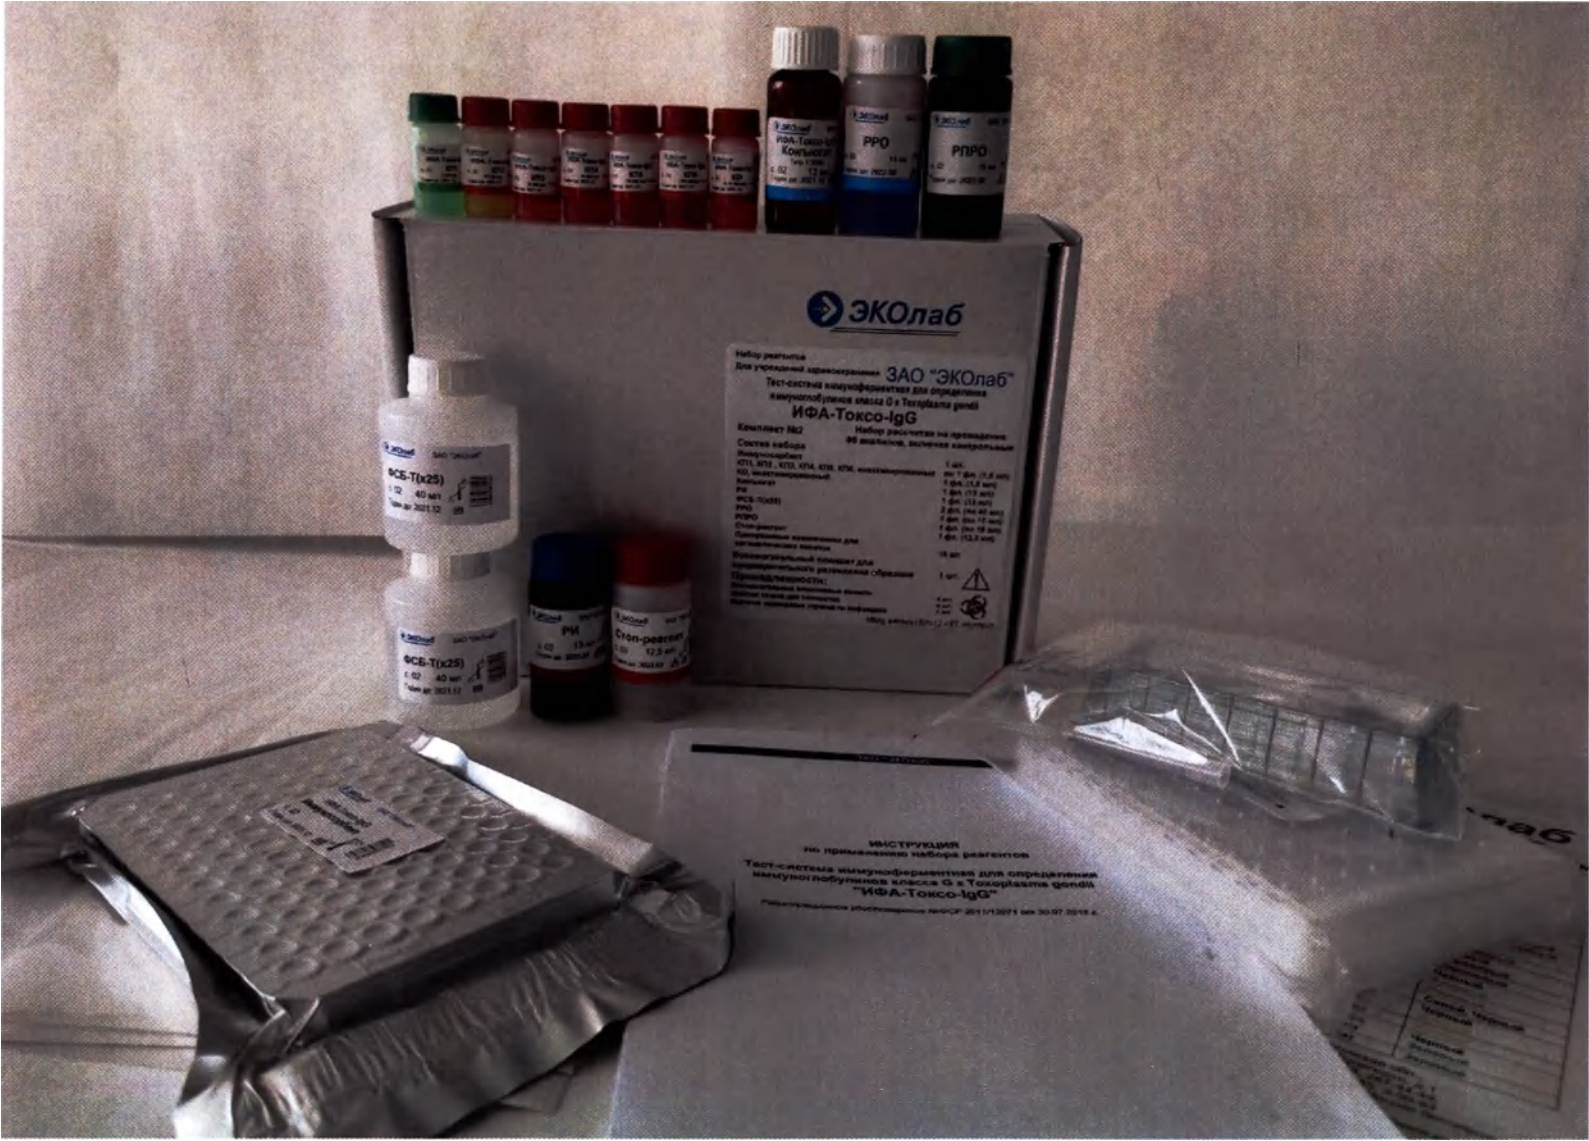

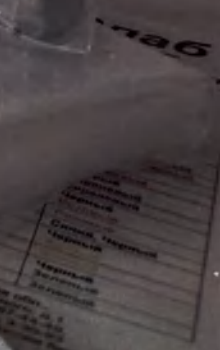



В.Ю. Борисов

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 2

Зам Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения

антител класса G к *Toxoplasma gondii*

ИФА-Токсо-IgG

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

КП1, КП2, КП3, КП4, КП5, КП6, инактивированные

КО, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РРО

РПРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

1 шт.

по 1 фл. (1,5 мл)

1 фл. (1,5 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (по 15 мл)

1 фл. (по 15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

ИФА-Токсо-IgG

ТУ 9398-076-70423725-2020

ПУ №ФСР 2011/12071 от 30.07.2018

Комплект №1

Каталожный №

05.03.01

Серия

01







Контрольный №

209

Дата изготовления: 2020.06.15

Годен до: 2021.12.15

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

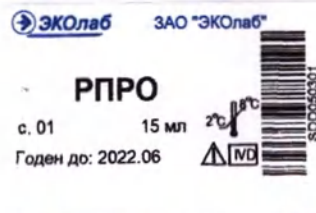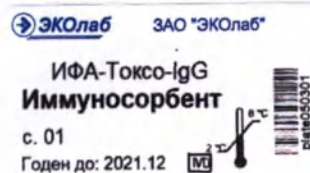

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения

антител класса G к *Toxoplasma gondii*

ИФА-Токсо-IgG

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
КП1, КП2, КП3, КП4, КП5, КП6, инактивированные

КО, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(х25)

РРО

РПРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

1 шт.
по 1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (13 мл)
1 фл. (13 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 фл. (по 15 мл)
1 фл. (по 15 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

1 шт.

4 шт.
4 шт.
1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

ИФА-Токсо-IgG

ТУ 9398-076-70423725-2020

РУ №ФСР 2011/12071 от 30.07.2018

Комплект №2

Каталожный № 05.03.02


Серия 02

Контрольный № 210

Дата изготовления: 2020.06.15










Годен до: 2021.12.15

ЗАО «ЭКОлаб»



05.03.02

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

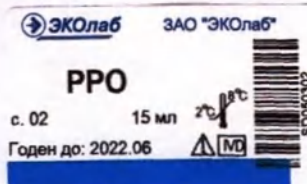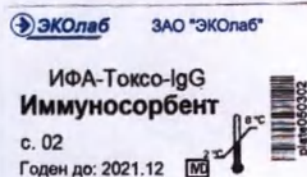

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а


Зам.Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

09 2021 г.



Фотографическое изображение карточки маркировки стрипов

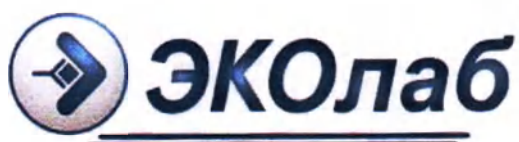

Маркировка стрипов по инфекциям

Наименование ИФТС	Место нанесения маркировки	Цвет маркировки
ИФА - Краснуха IgM	Верх	Черный
ИФА - Краснуха IgG	Низ	Красный
ИФА - ВПГ1+2 IgM	Верх	Черный
ИФА - ВПГ 1 IgG	Низ	Голубой
ИФА - ВПГ 2 IgG	Низ	Синий
ИФА-Хеликобактер IgA	Верх	Красный
ИФА-Хеликобактер IgG	Низ	Голубой, медный
ИФА - Токсо IgM	-	-
ИФА - Токсо IgG	Низ	Оранжевый
ИФА - Корь IgM	Верх	Черный
ИФА - Корь IgG	Низ	Сиреневый
ИФА - Паротит IgM	Верх	Черный
ИФА - Паротит IgG	Низ	Розовый
ИФА - ВПГ1+2 IgG	Низ	Синий, Черный
ИФА - ЦМВ IgM	Верх	Черный
ИФА - ЦМВ IgG	Низ	Желтый
ИФА - Боррелия IgM	Верх	Черный
ИФА - Боррелия IgG	Низ	Зеленый

142530, РФ, Московская обл.,
г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1а
тел.: +7 (496) 433-30-93
8-800-333-33-47 (звонок по России бесплатный)
e-mail: ekolab-sbyt@mail.ru <http://www.ekolab.ru>

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко



Фотографическое изображение и маркировка планшета для предварительного разведения образцов.

Маркировка¹ планшета для предварительного разведения образцов



**Планшет
для предварительного
разведения образцов**

Фотографическое изображение² планшета для предварительного разведения образцов



Примечание:

Маркировка¹ планшета унифицирована для всех наборов производства ЗАО «ЭКОлаб», где требуется предварительное разведение образцов.

Фотографическое изображение² планшета для предварительного разведения образцов (Планшет полимерный плоскодонный для иммуноферментных исследований однократного применения Пп-"Б-М" разборный с фиксатором - ОАО «Биомедикал», Россия, РУ № ФСР 2010/08676).

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»



Т.Ю. Гашенко