


Фото набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к респираторно-синцитиальному вирусу» «ИФА-РСВ-IgG»

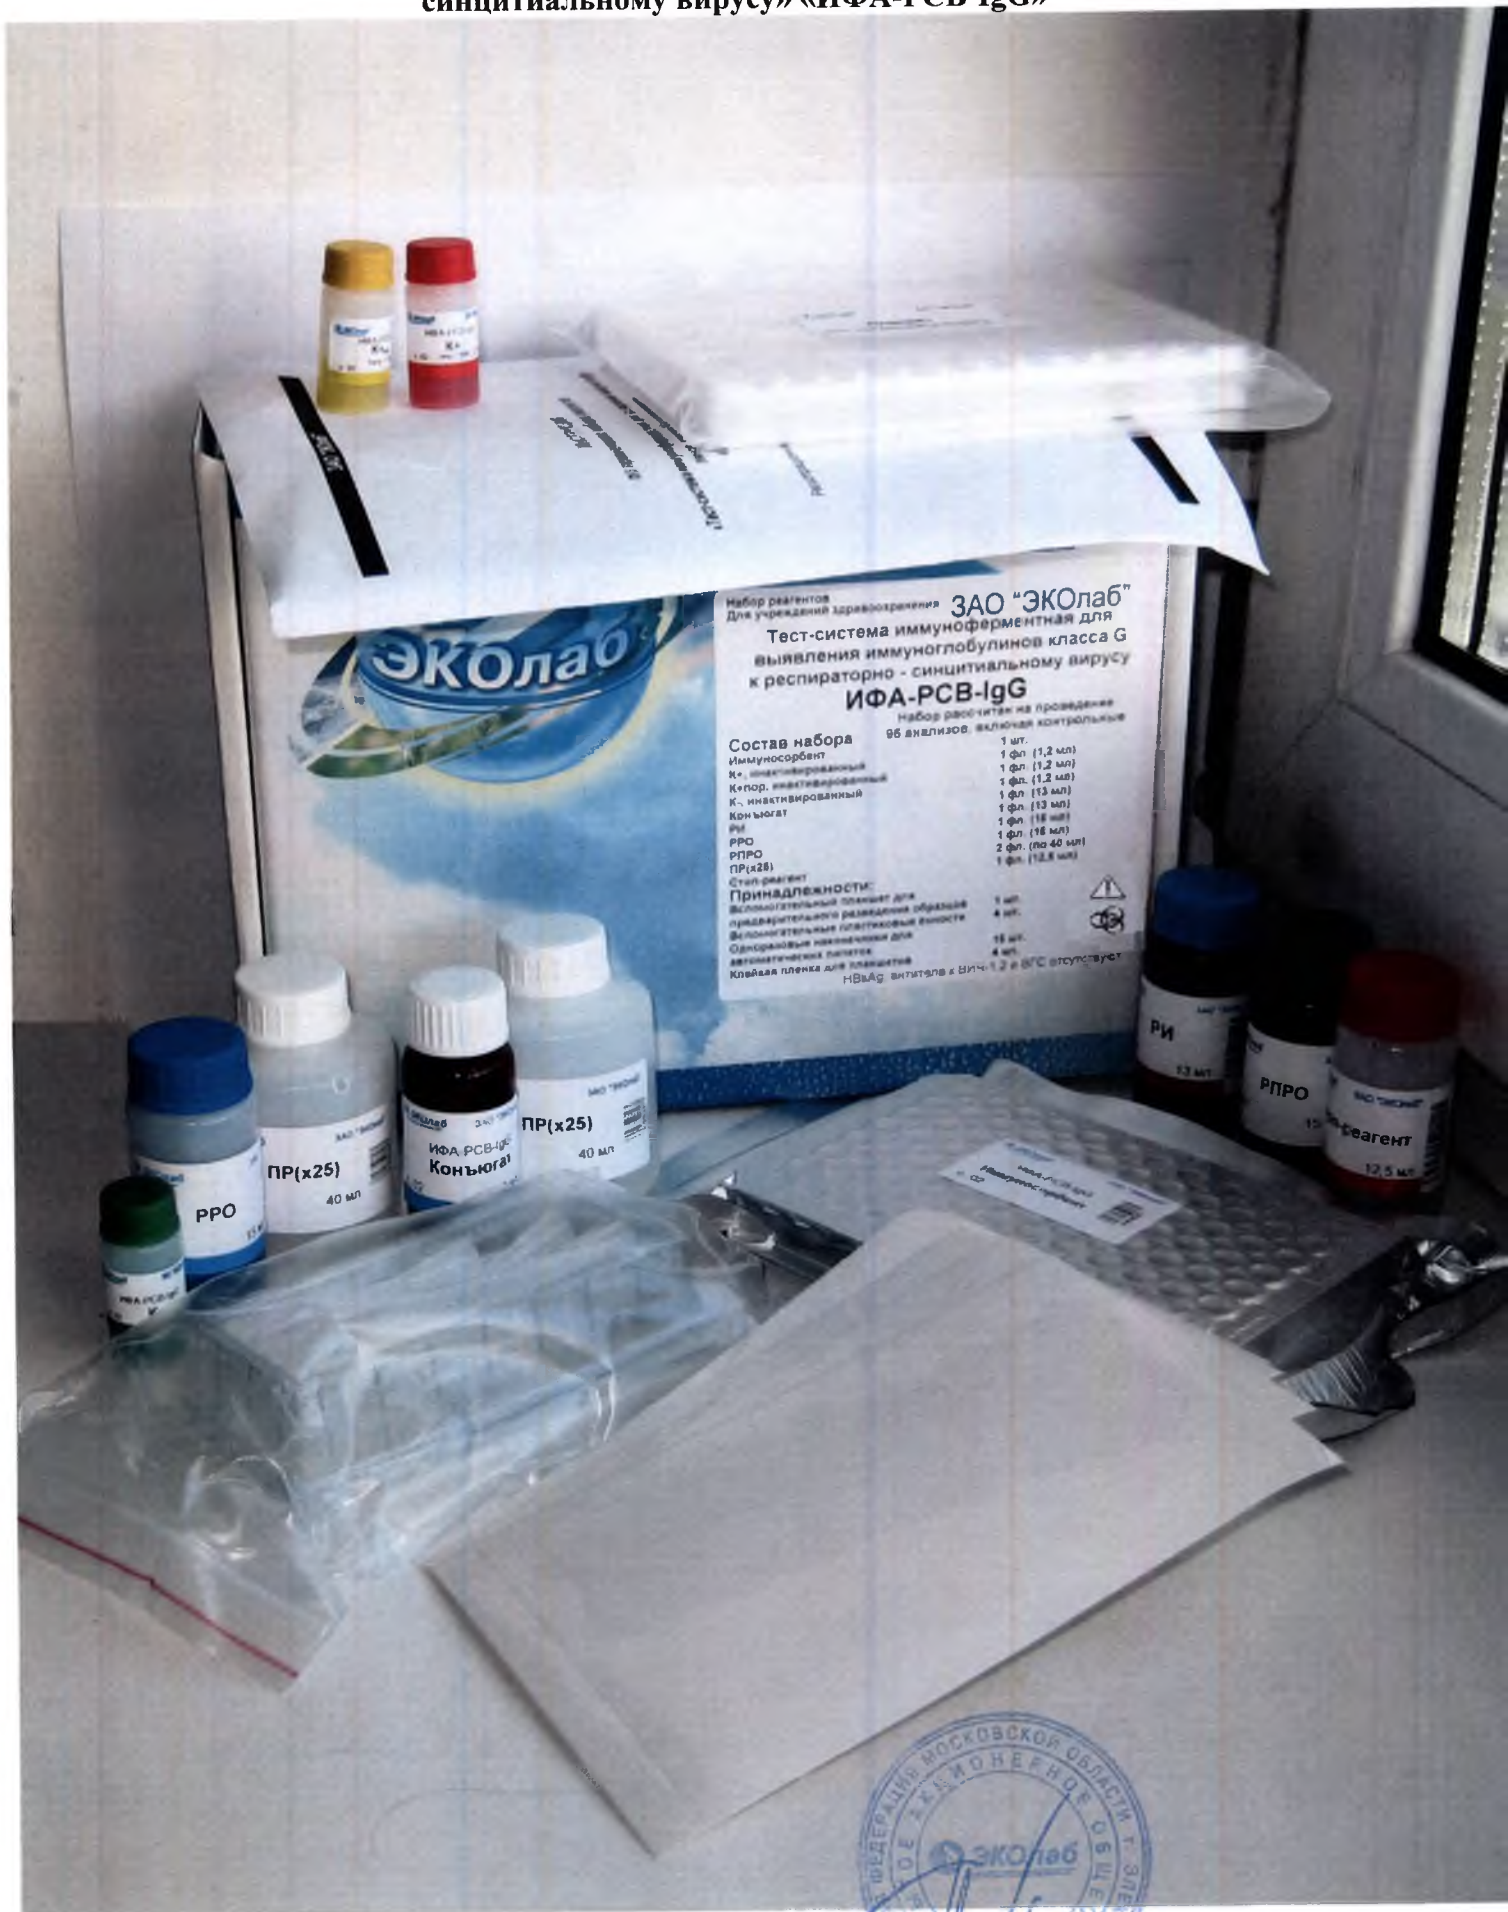

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 27 " 20 17 г.



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для
выявления иммуноглобулинов класса G
к респираторно - синцициальному вирусу

ИФА-PCB-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

ЗАО "ЭКОлаб"

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ПР(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РРО	1 фл. (16 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
РПРО	1 фл. (16 мл)

Принадлежности:

Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ИФА-PCB-IgG

ТУ 9398-162-70423725-2016

РУ №

Серия	02	Каталожный №	22.01
		Контрольный №	83

Дата изготовления: 2016.04

Голен до: 2017.04



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.



Директор производства ДП

Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.