

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»



Крупницкий Д.Е.

2024 г.

**УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023**

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**г. Санкт-Петербург
2024**


1. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш».
Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш15 М»

Автоклав модуль 1-15





Камера автоклава модуль 1-15




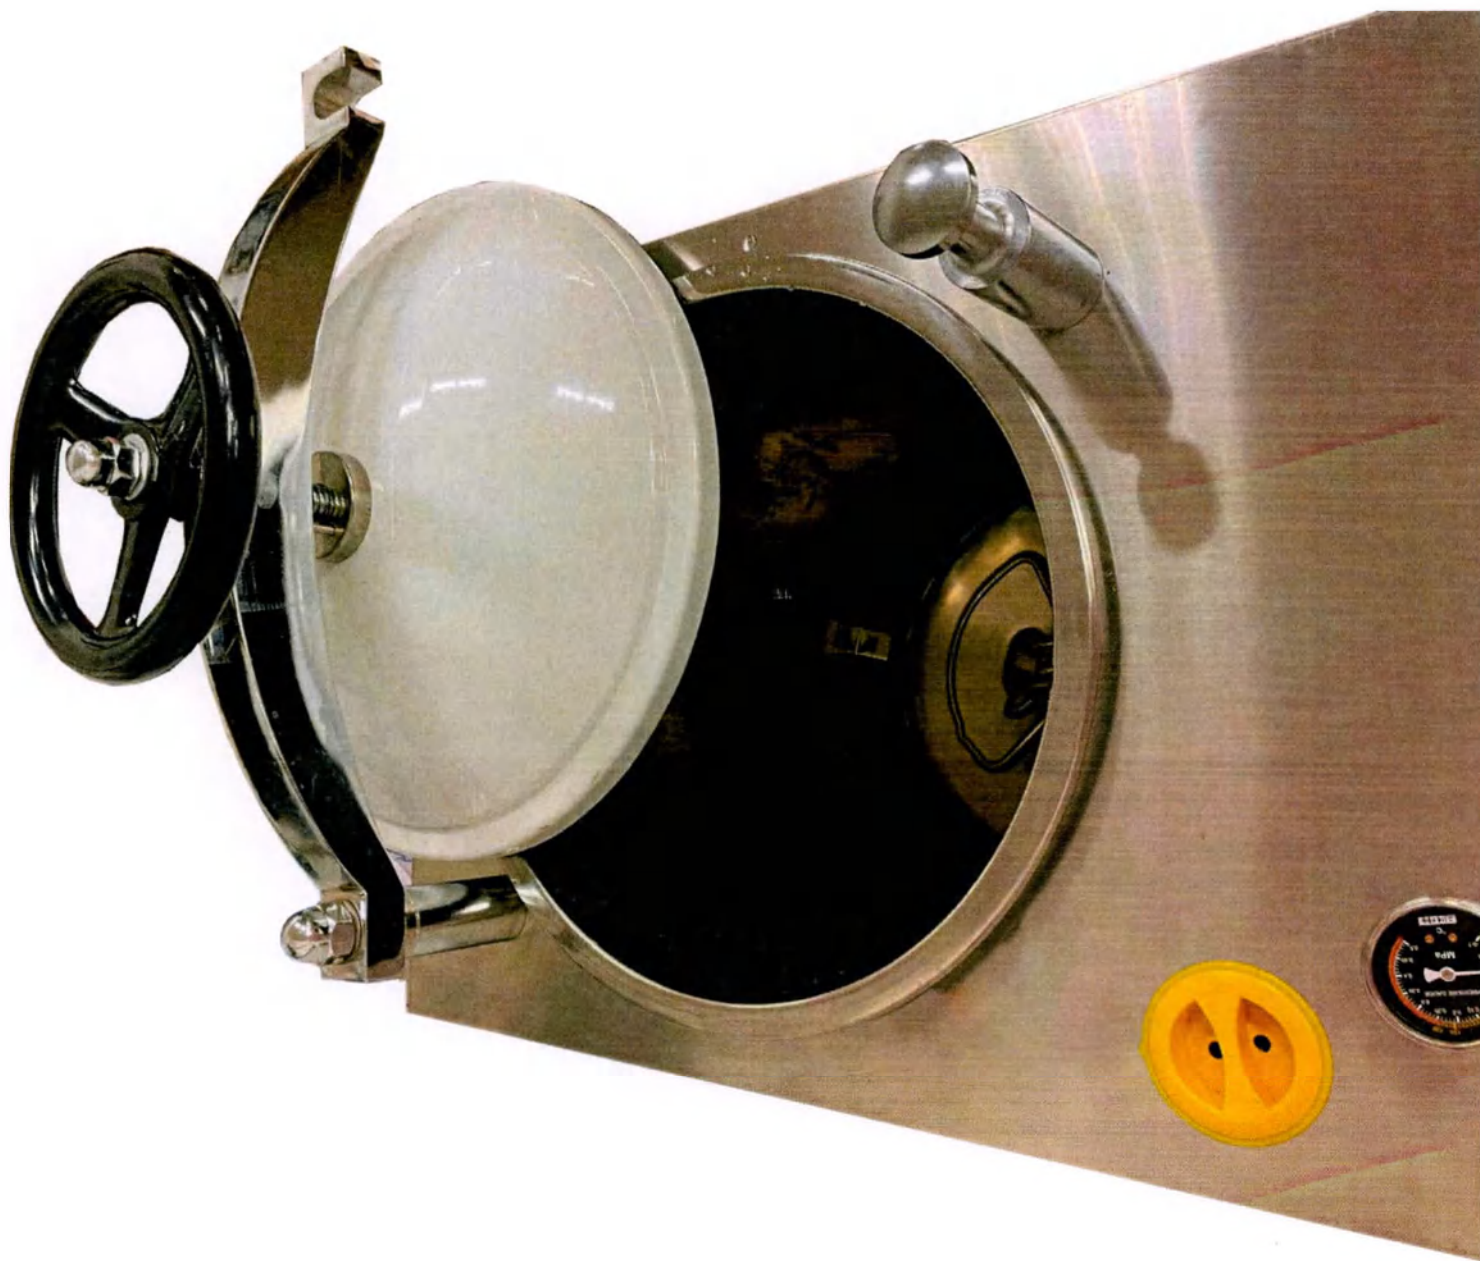



Шредер М модуль 2

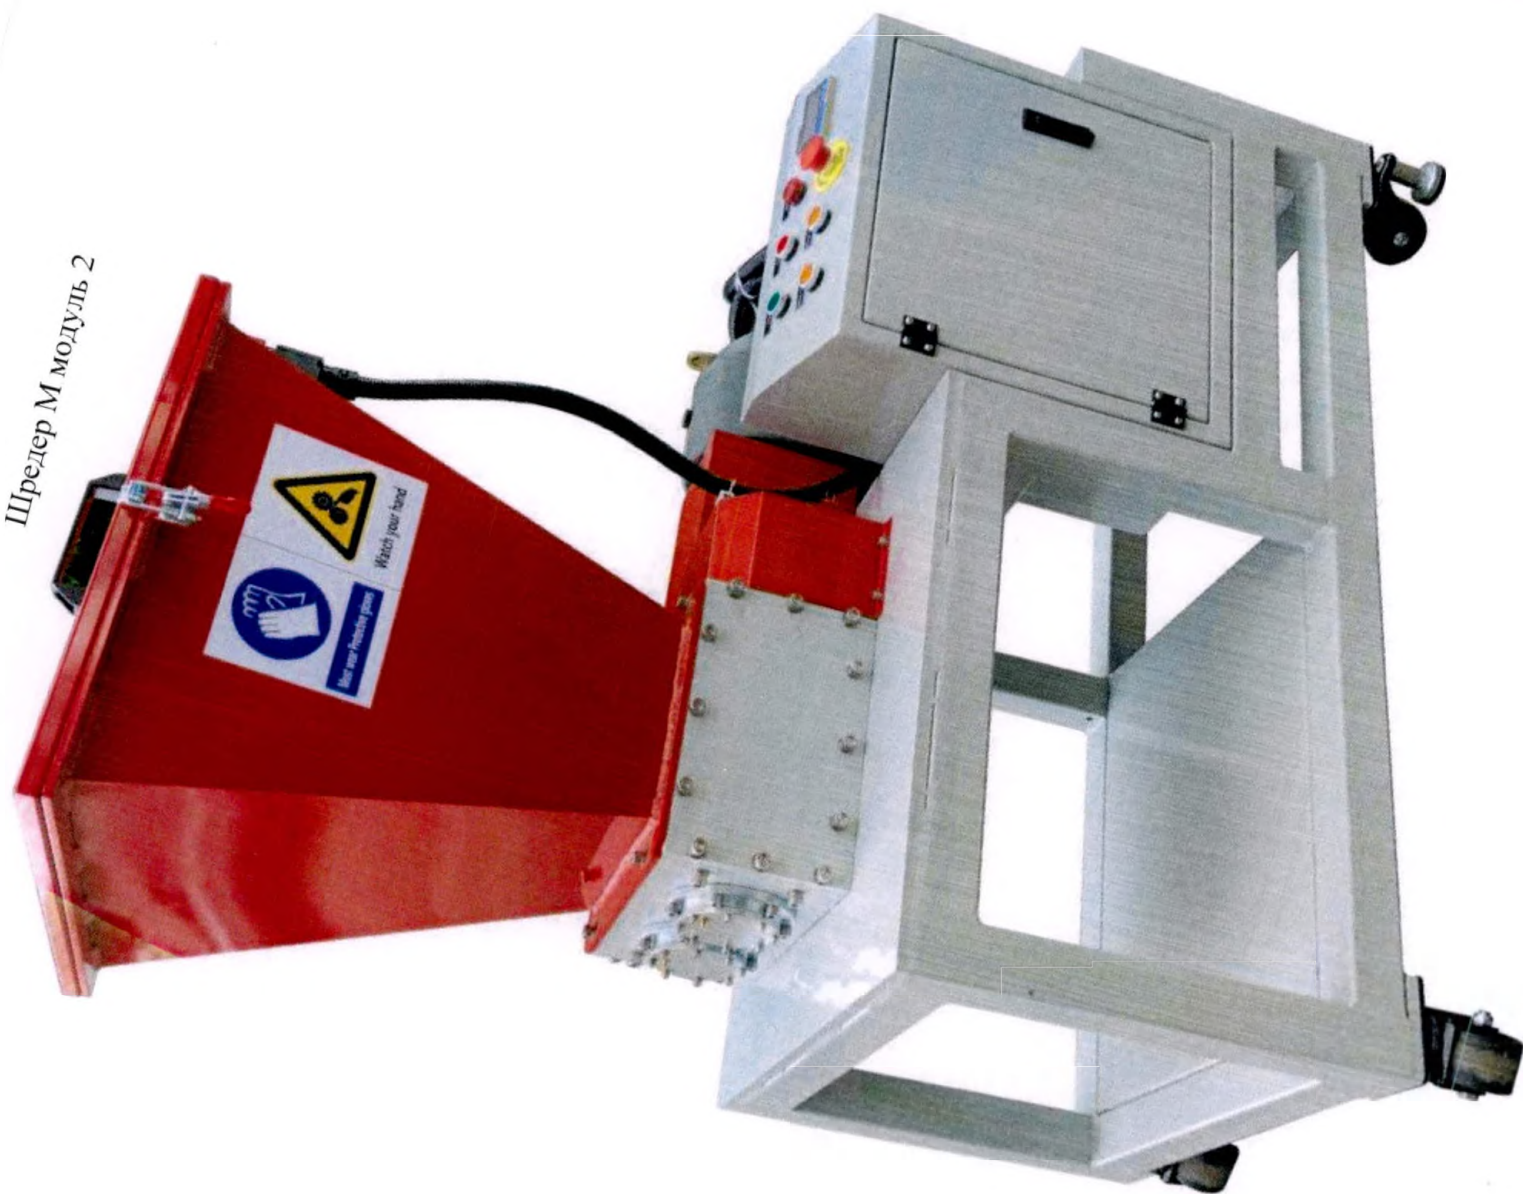


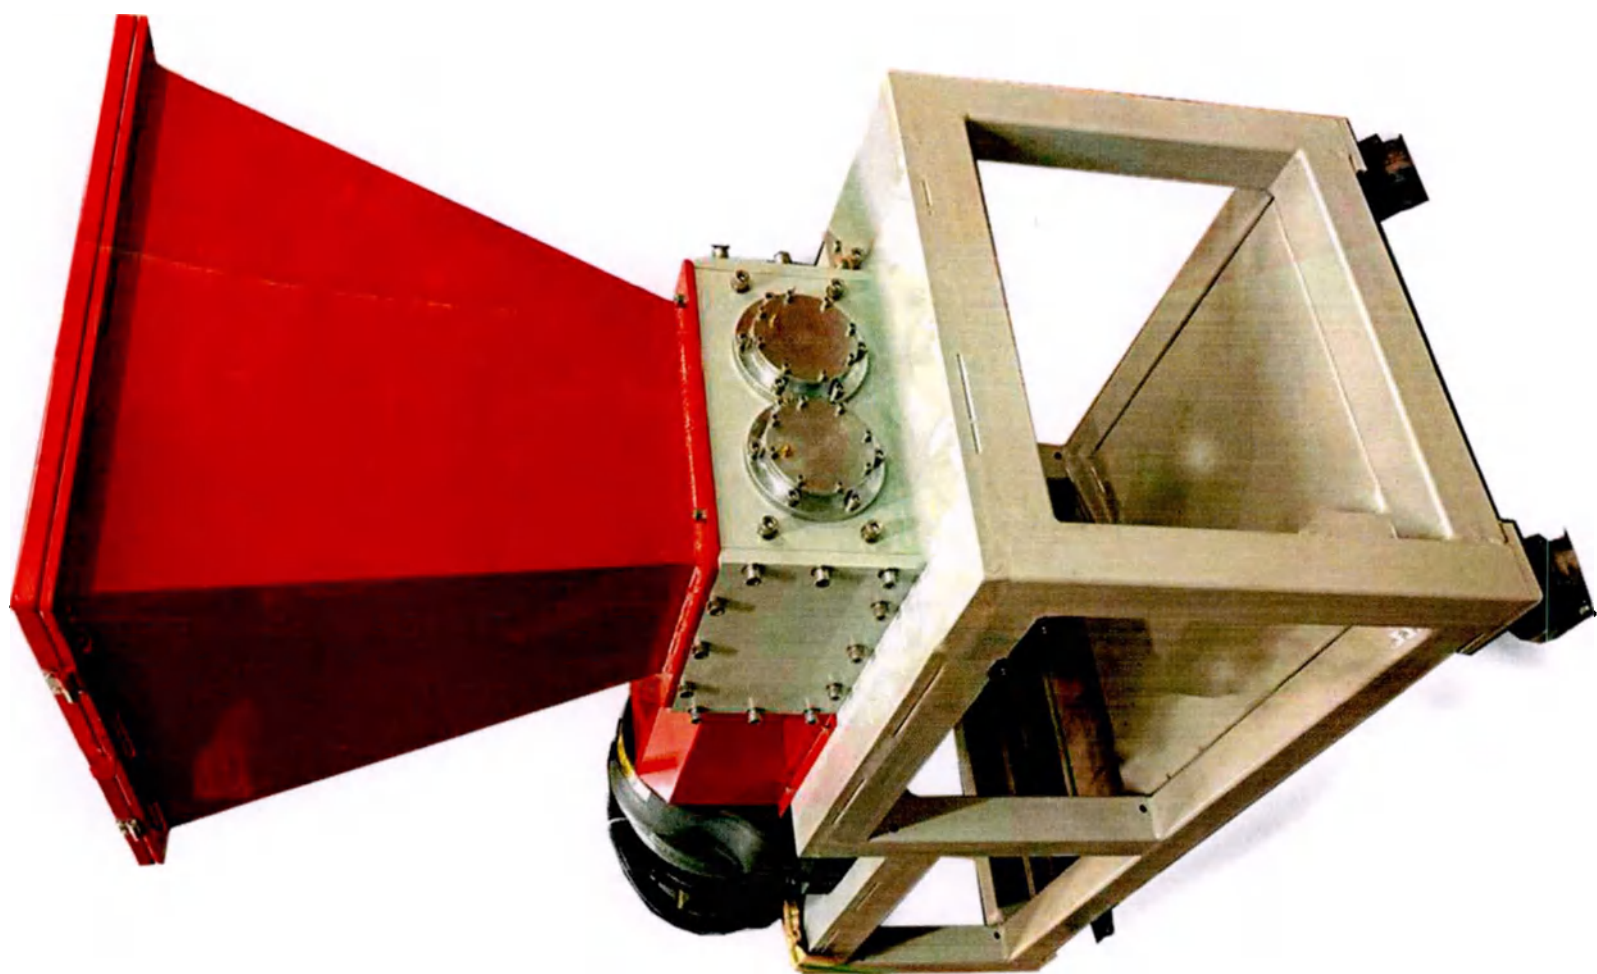

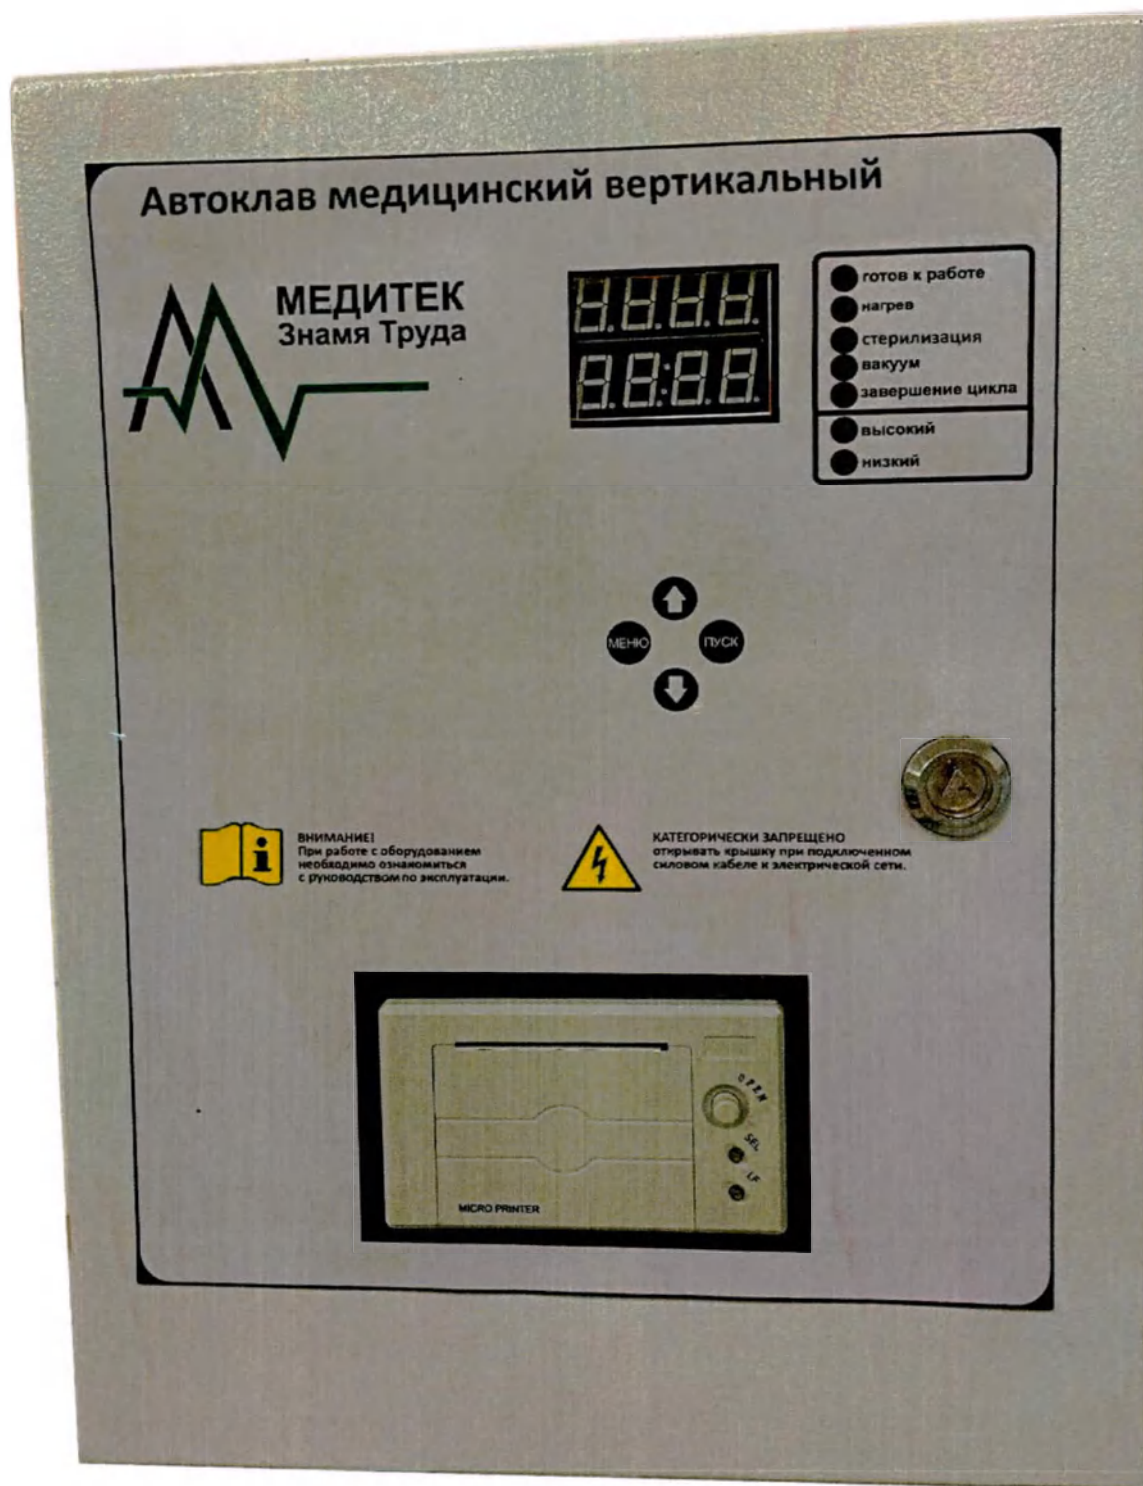

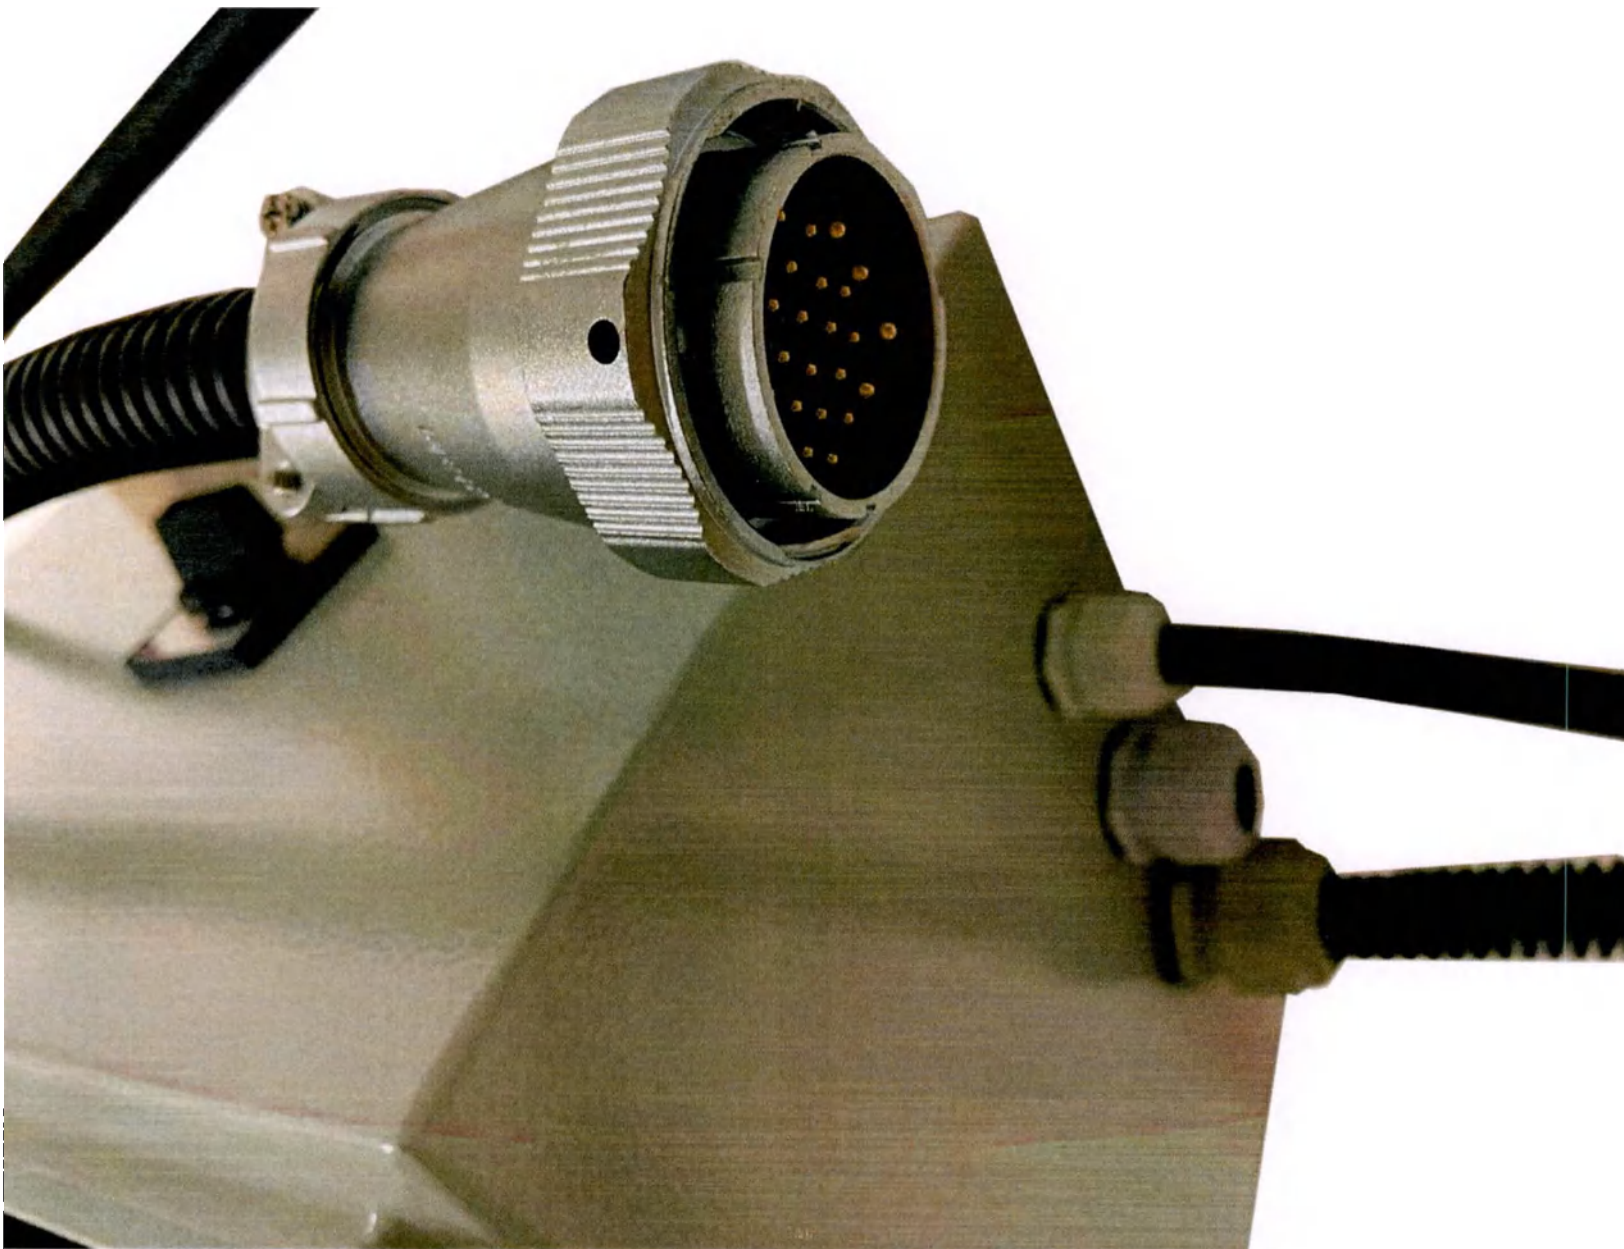

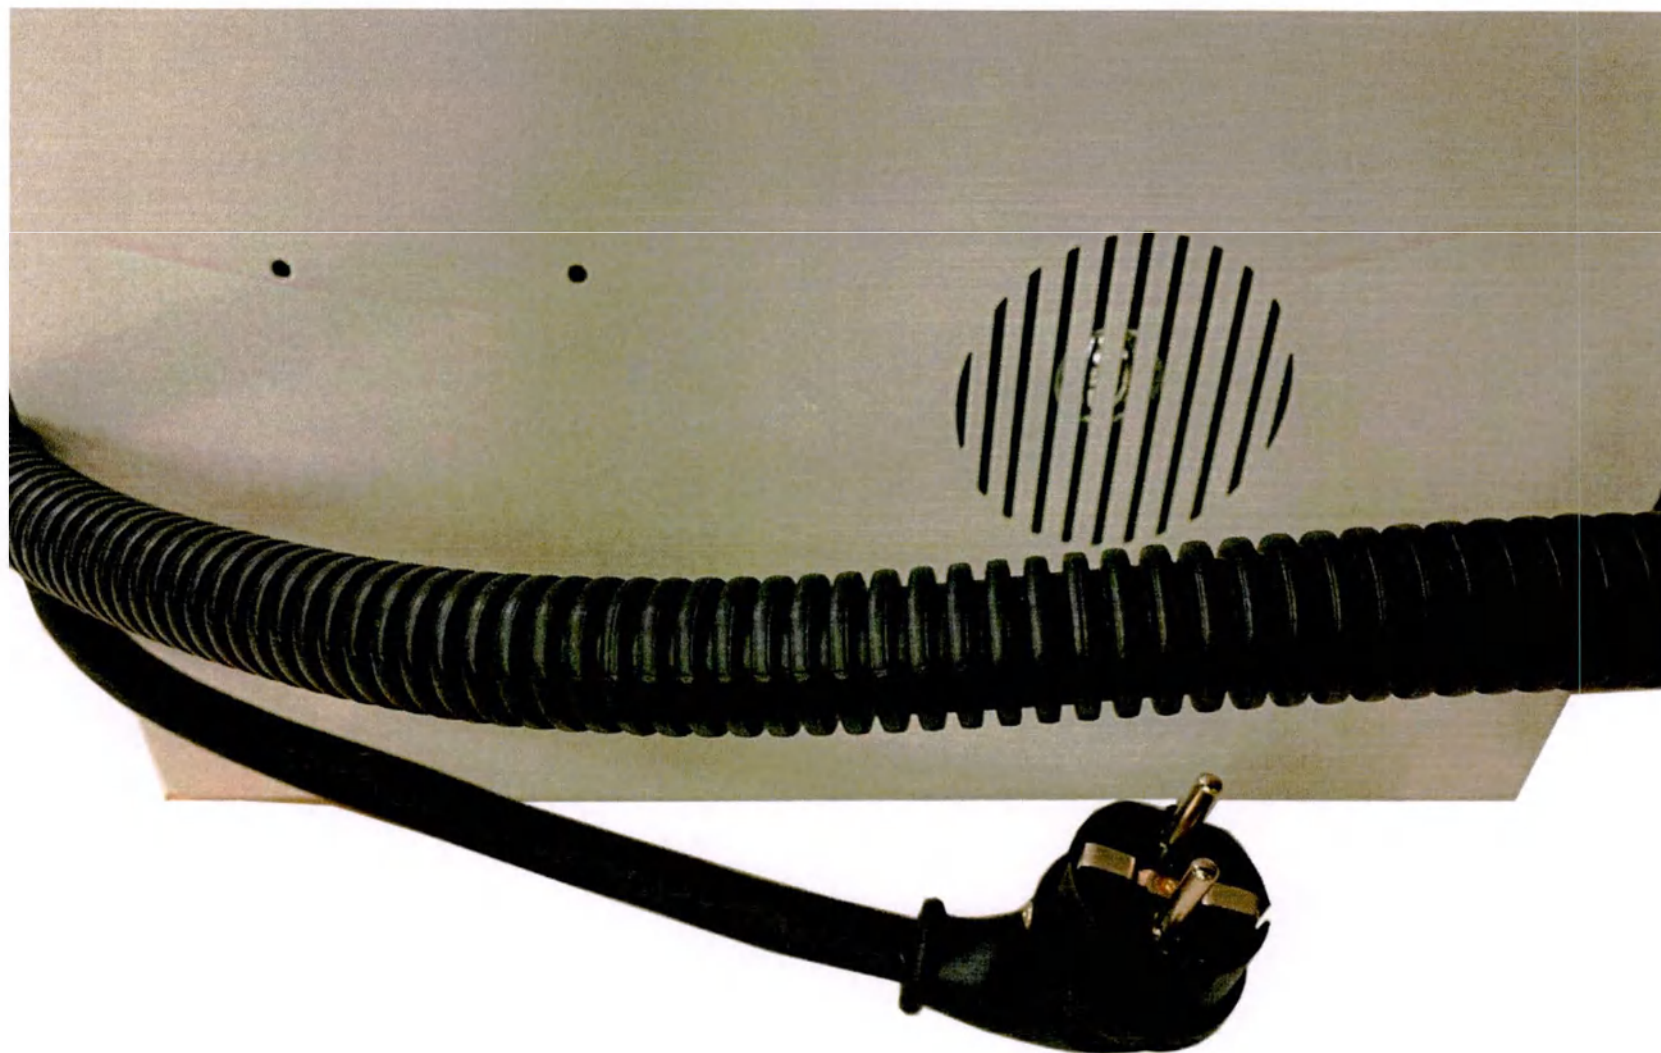


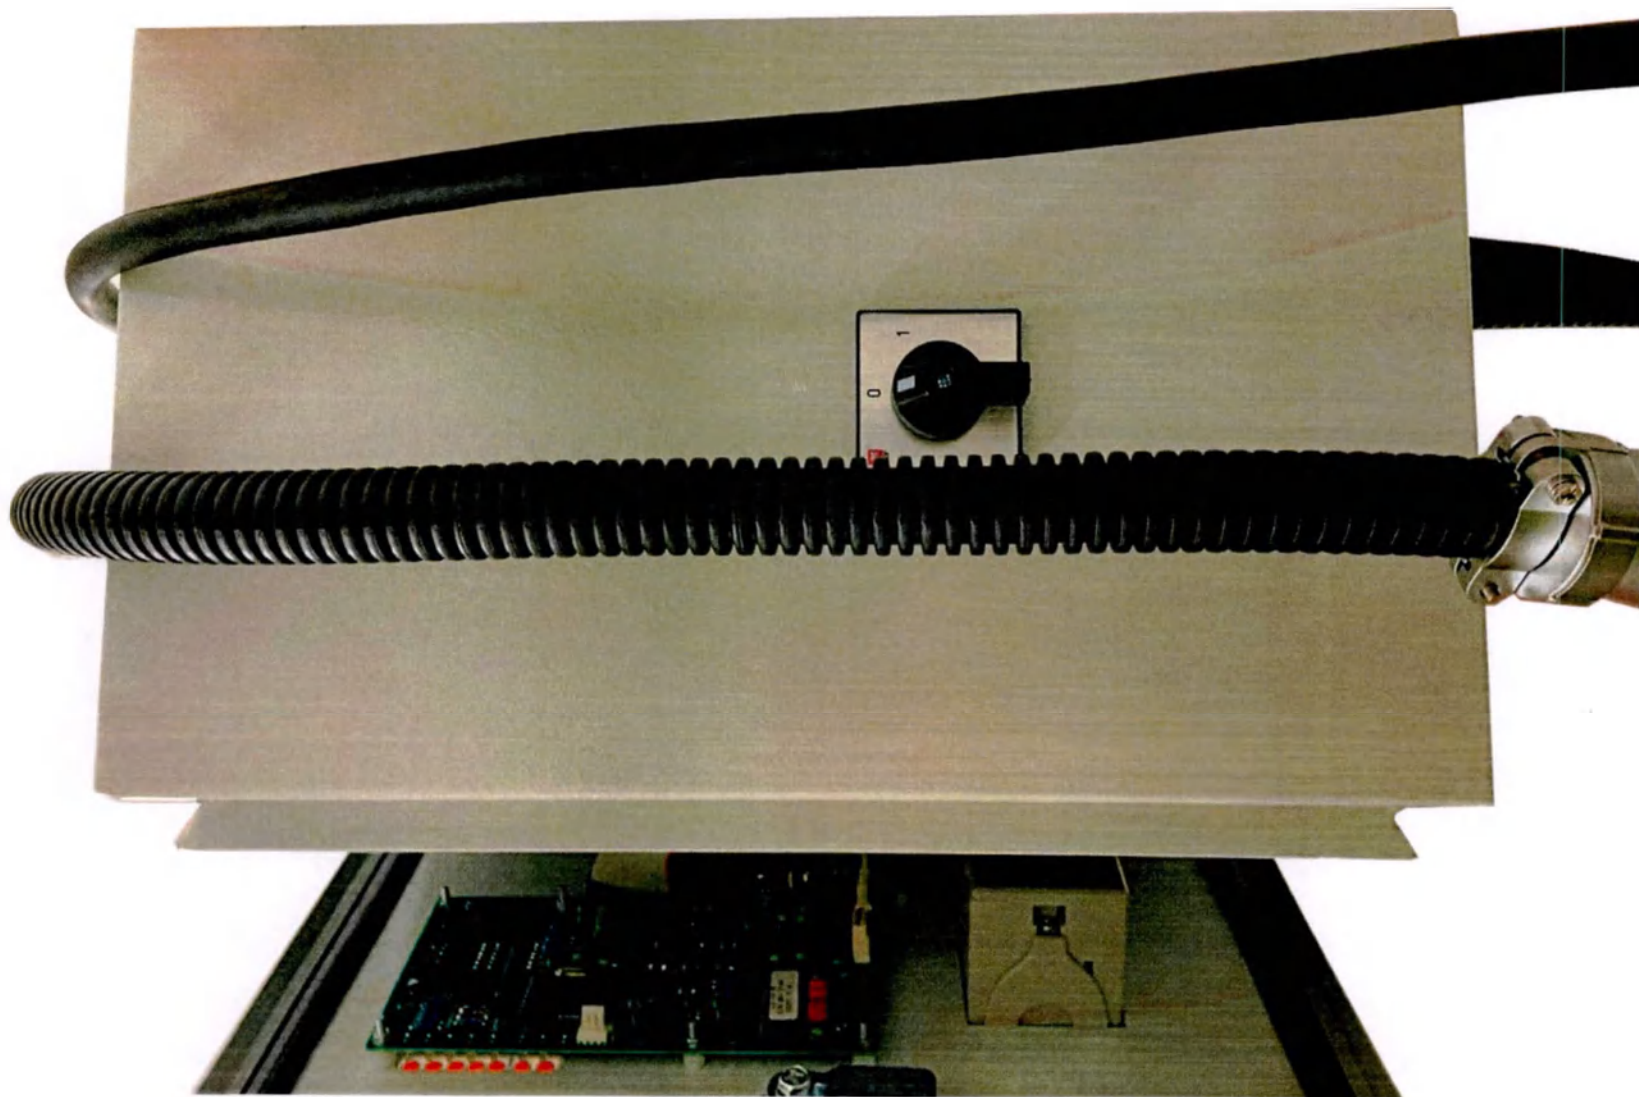


Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш15 М»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш15 М»

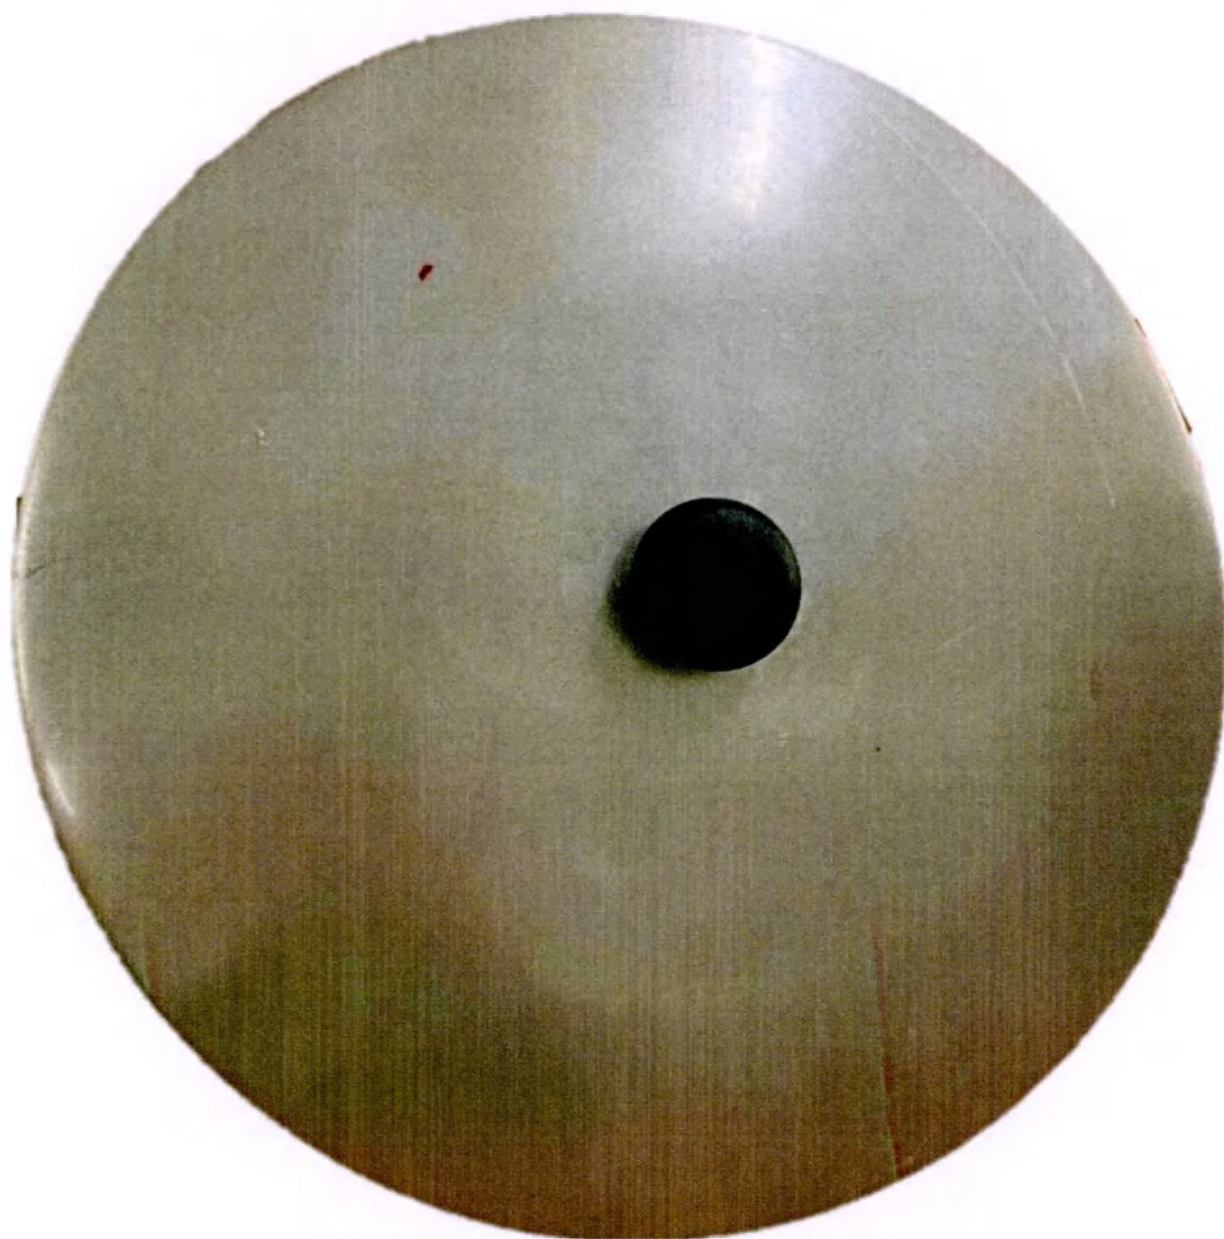

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш15 М»

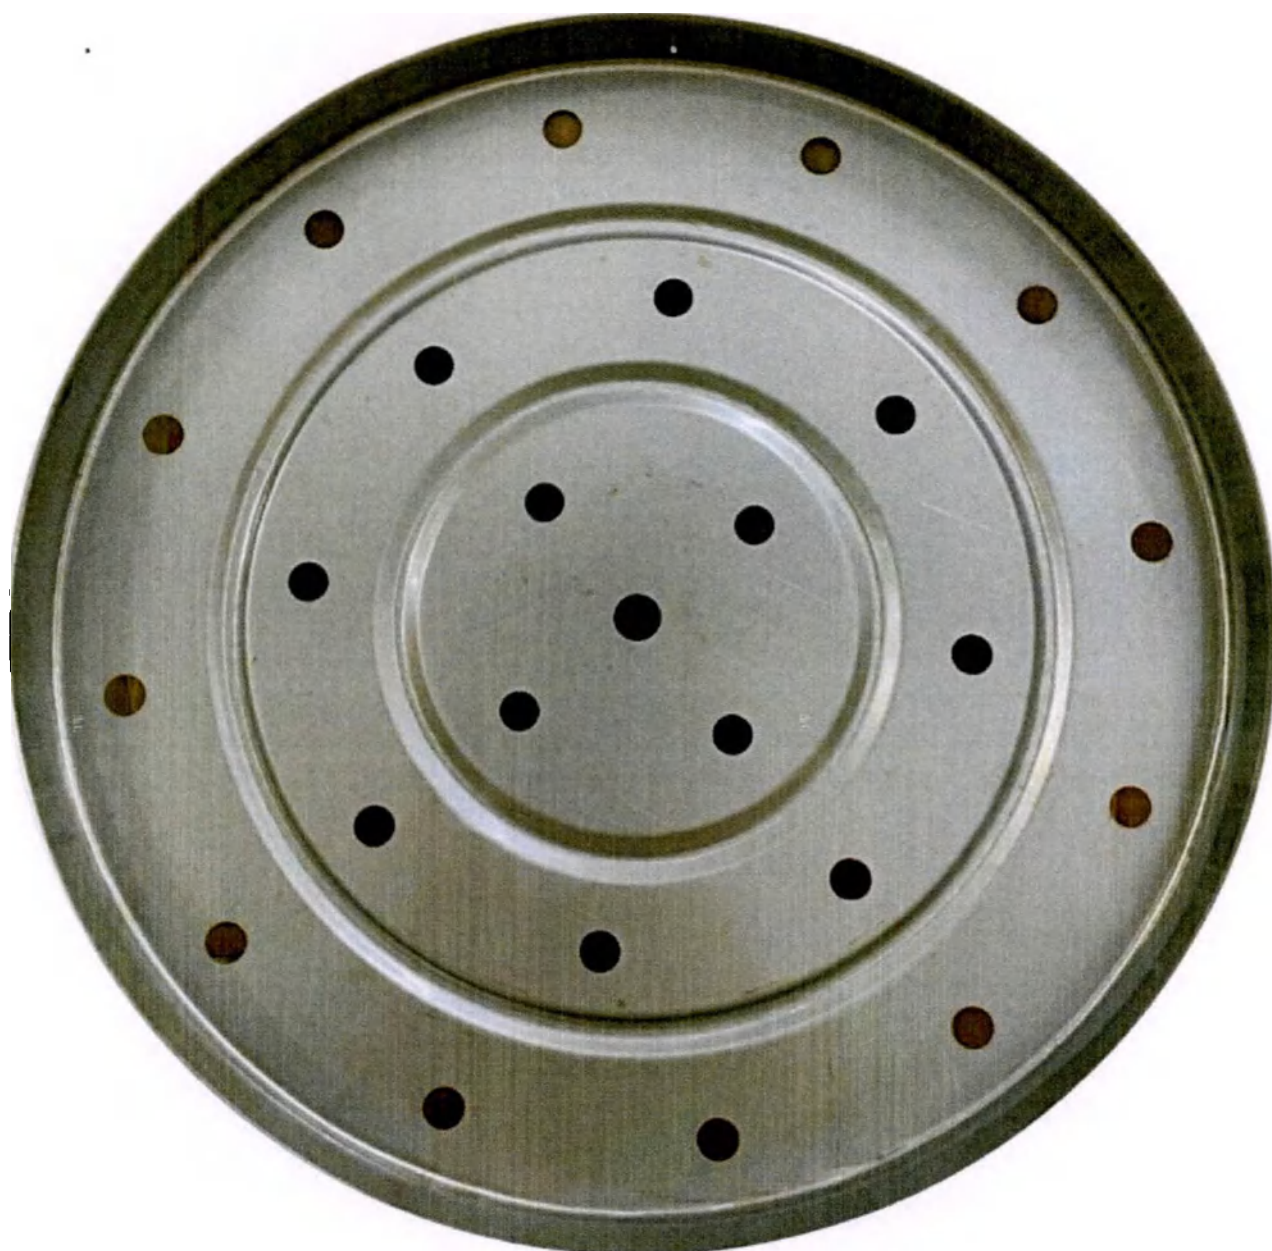




Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



Трубка полимерная металлическая

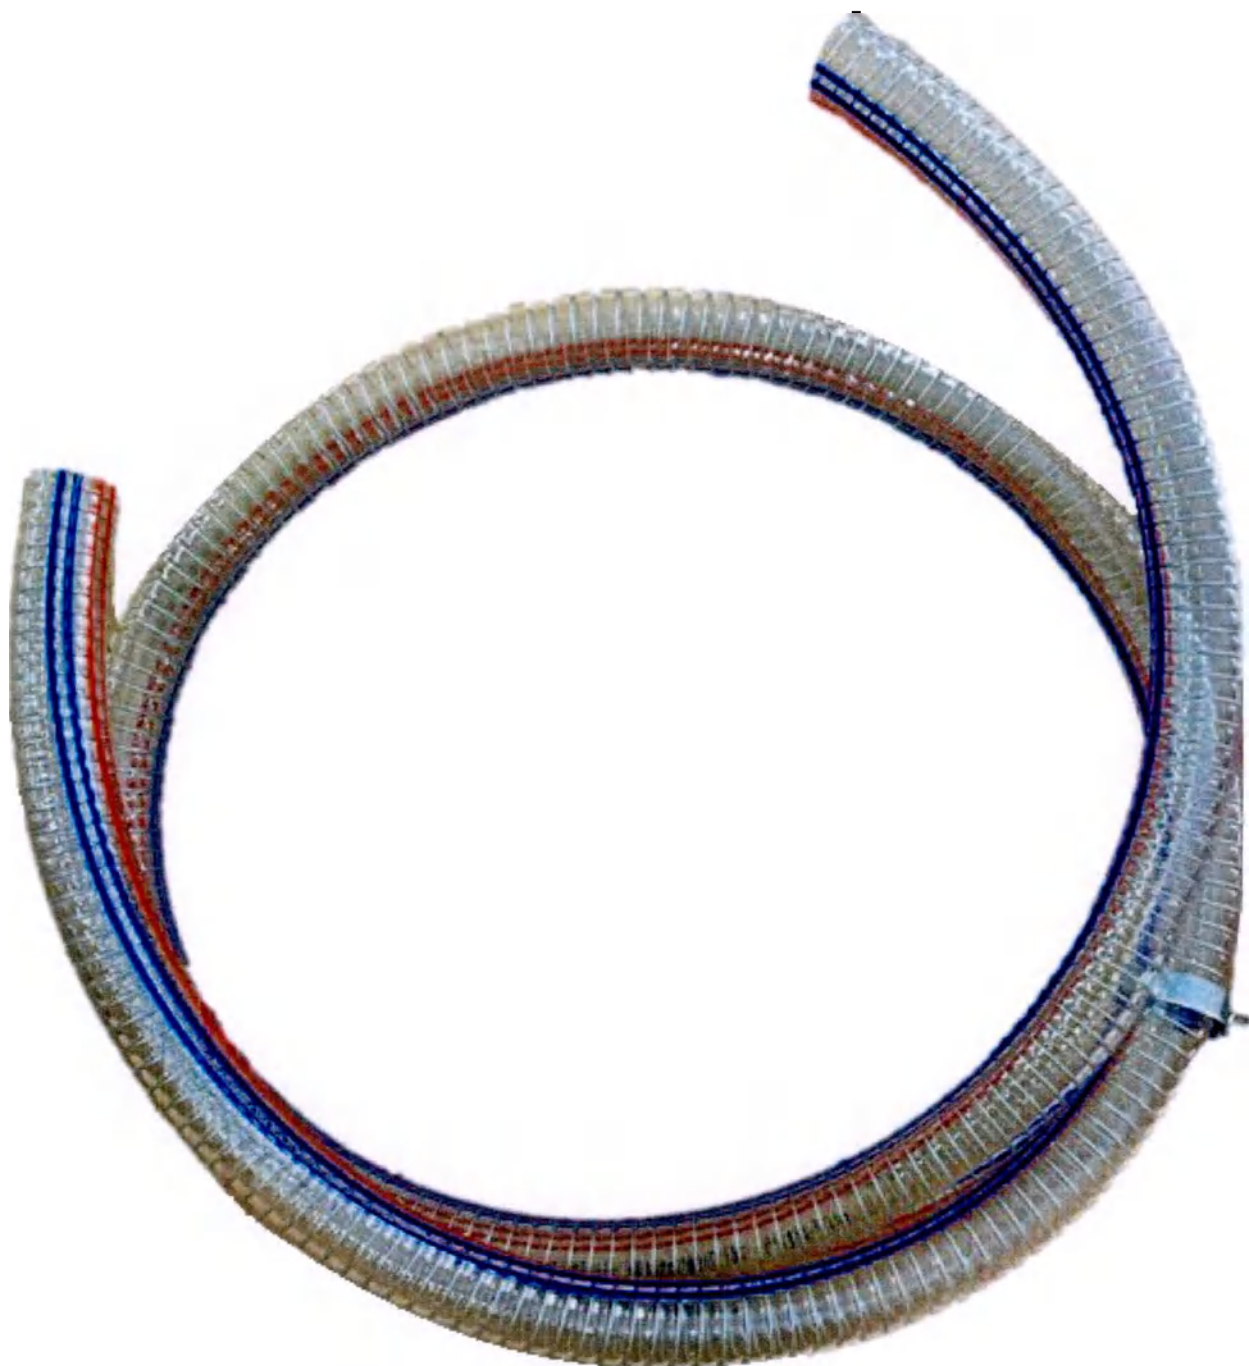

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-15



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-15



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, $\sim$ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 2,0 кВА

Объем стерилизационной камеры: 15 л

Максимальная рабочая температура: 126°C

Максимальное рабочее давление: 0,15 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00113



ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Маркировка Шредер М модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер М модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3 $\sim$ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА



07.2023 г.



00113



ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш15 М»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш15 М»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00113

2. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш30 М»

Автоклав модуль 1-30





Камера автоклава модуль 1-30

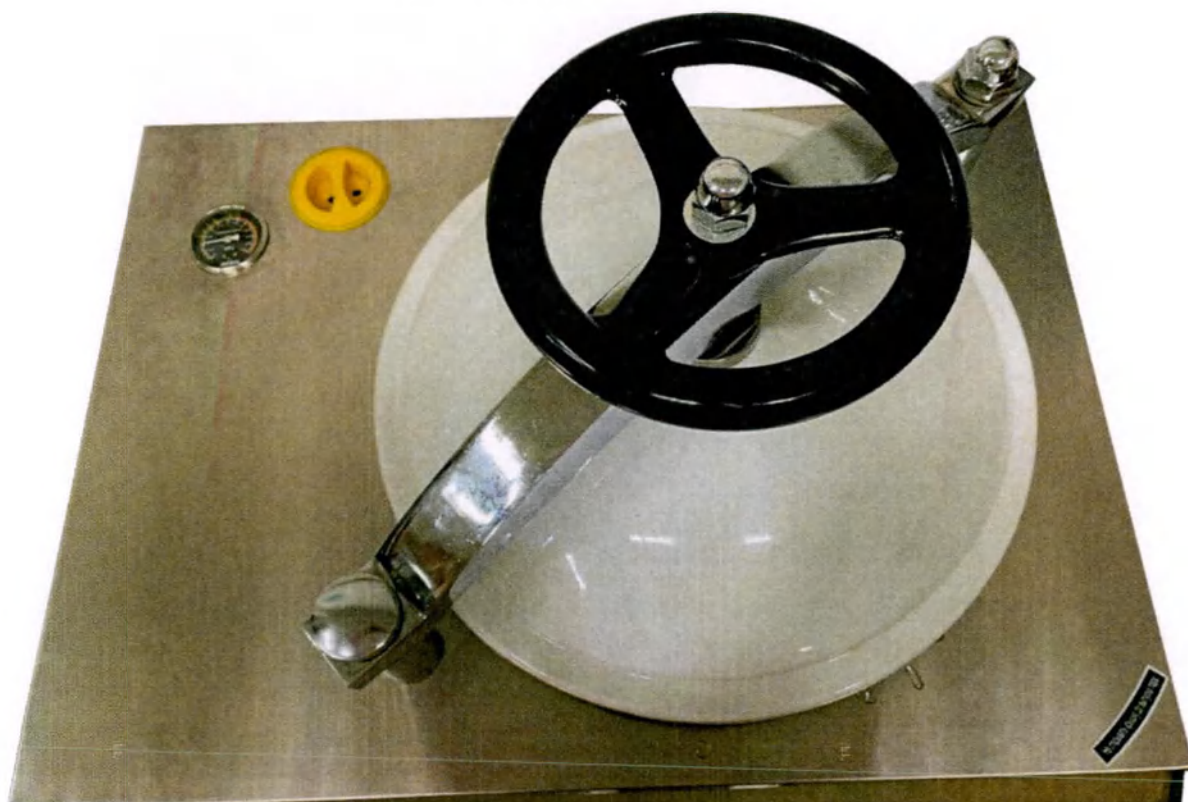








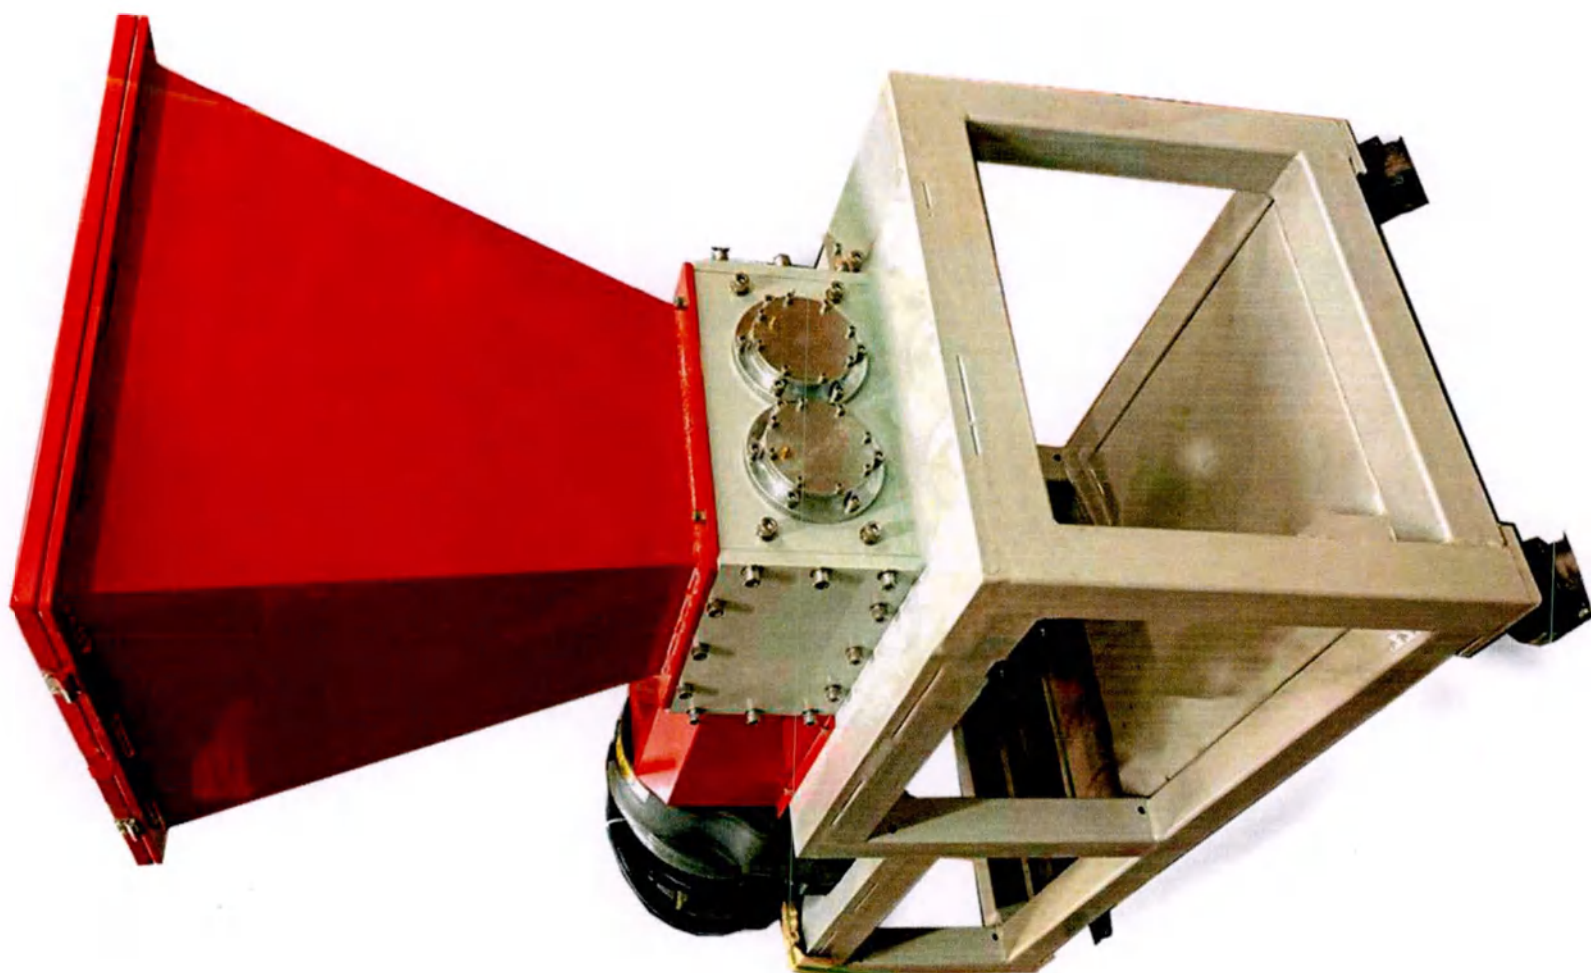

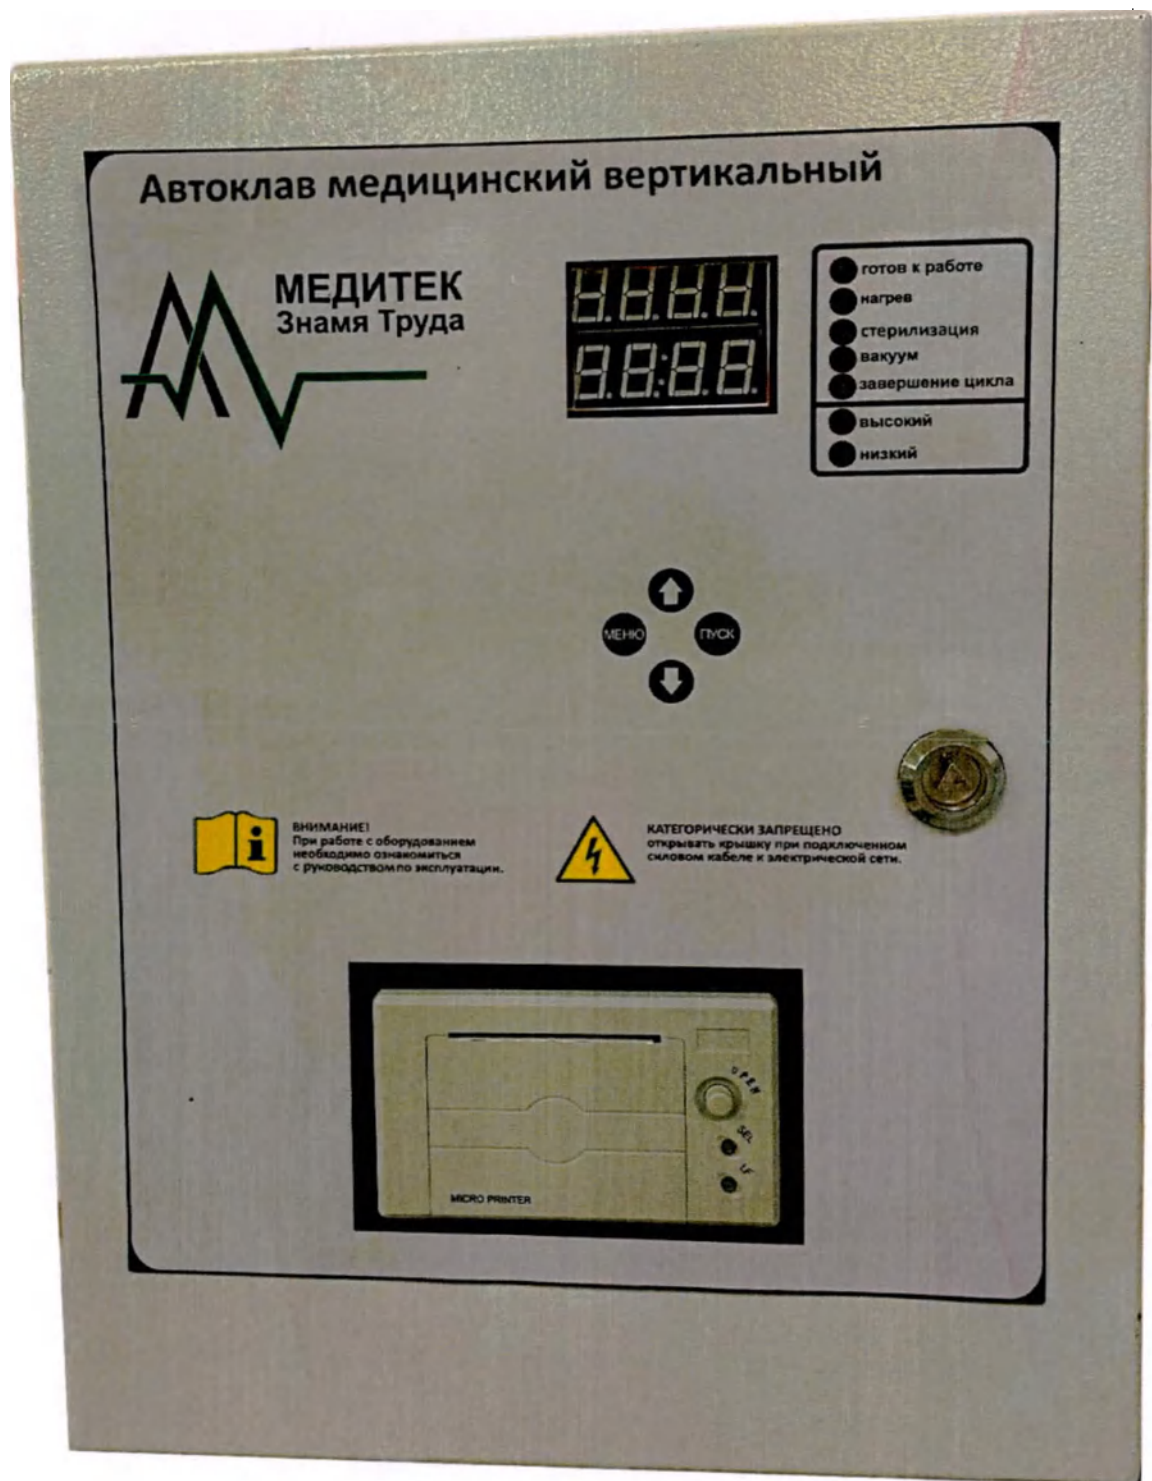

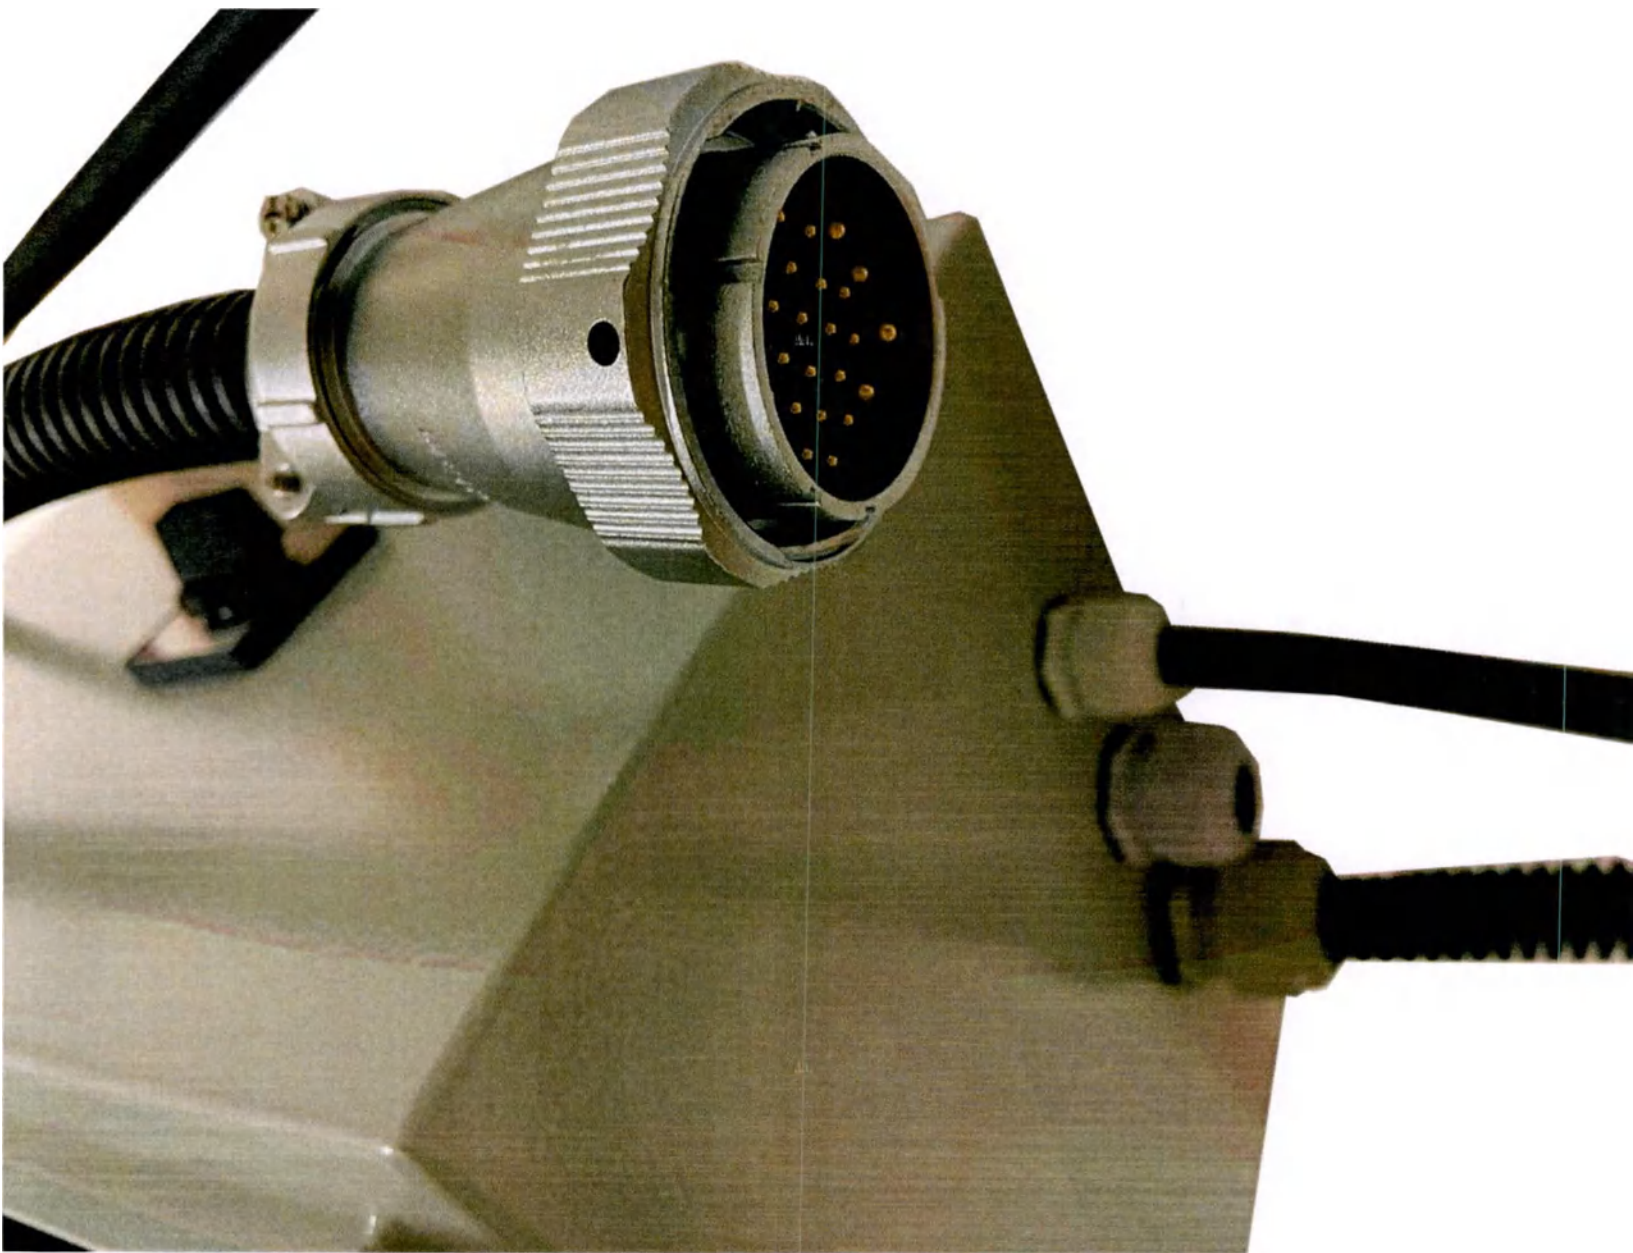

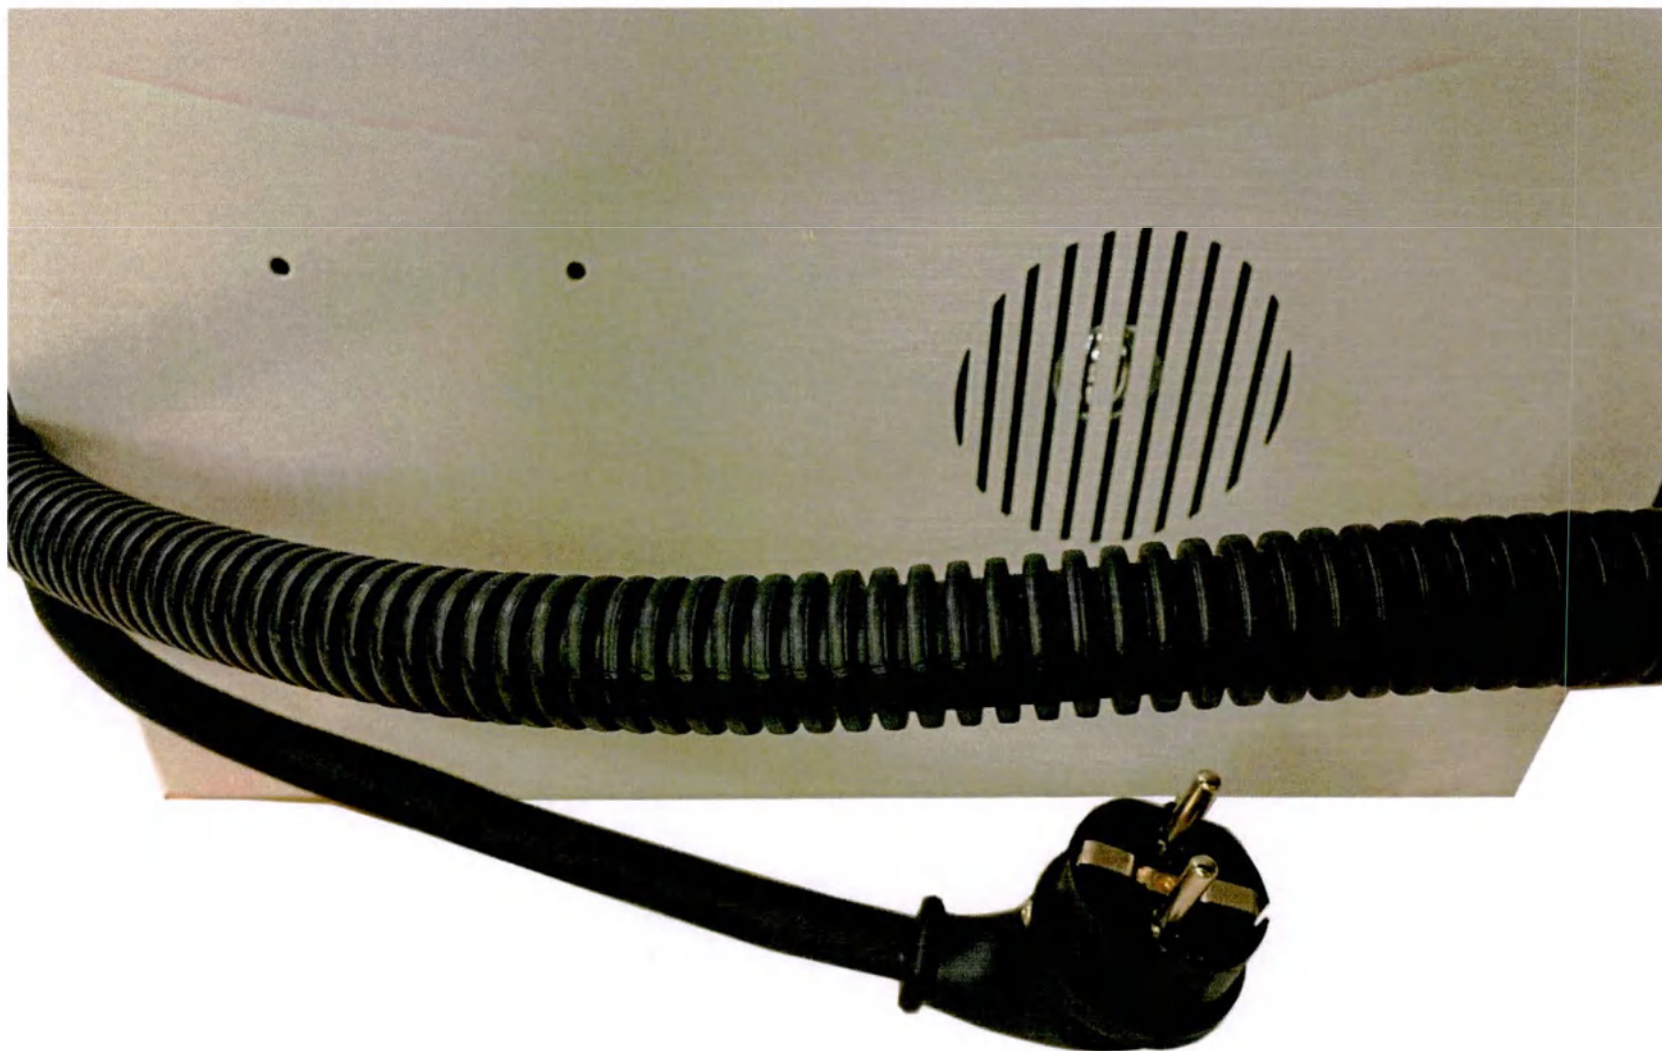


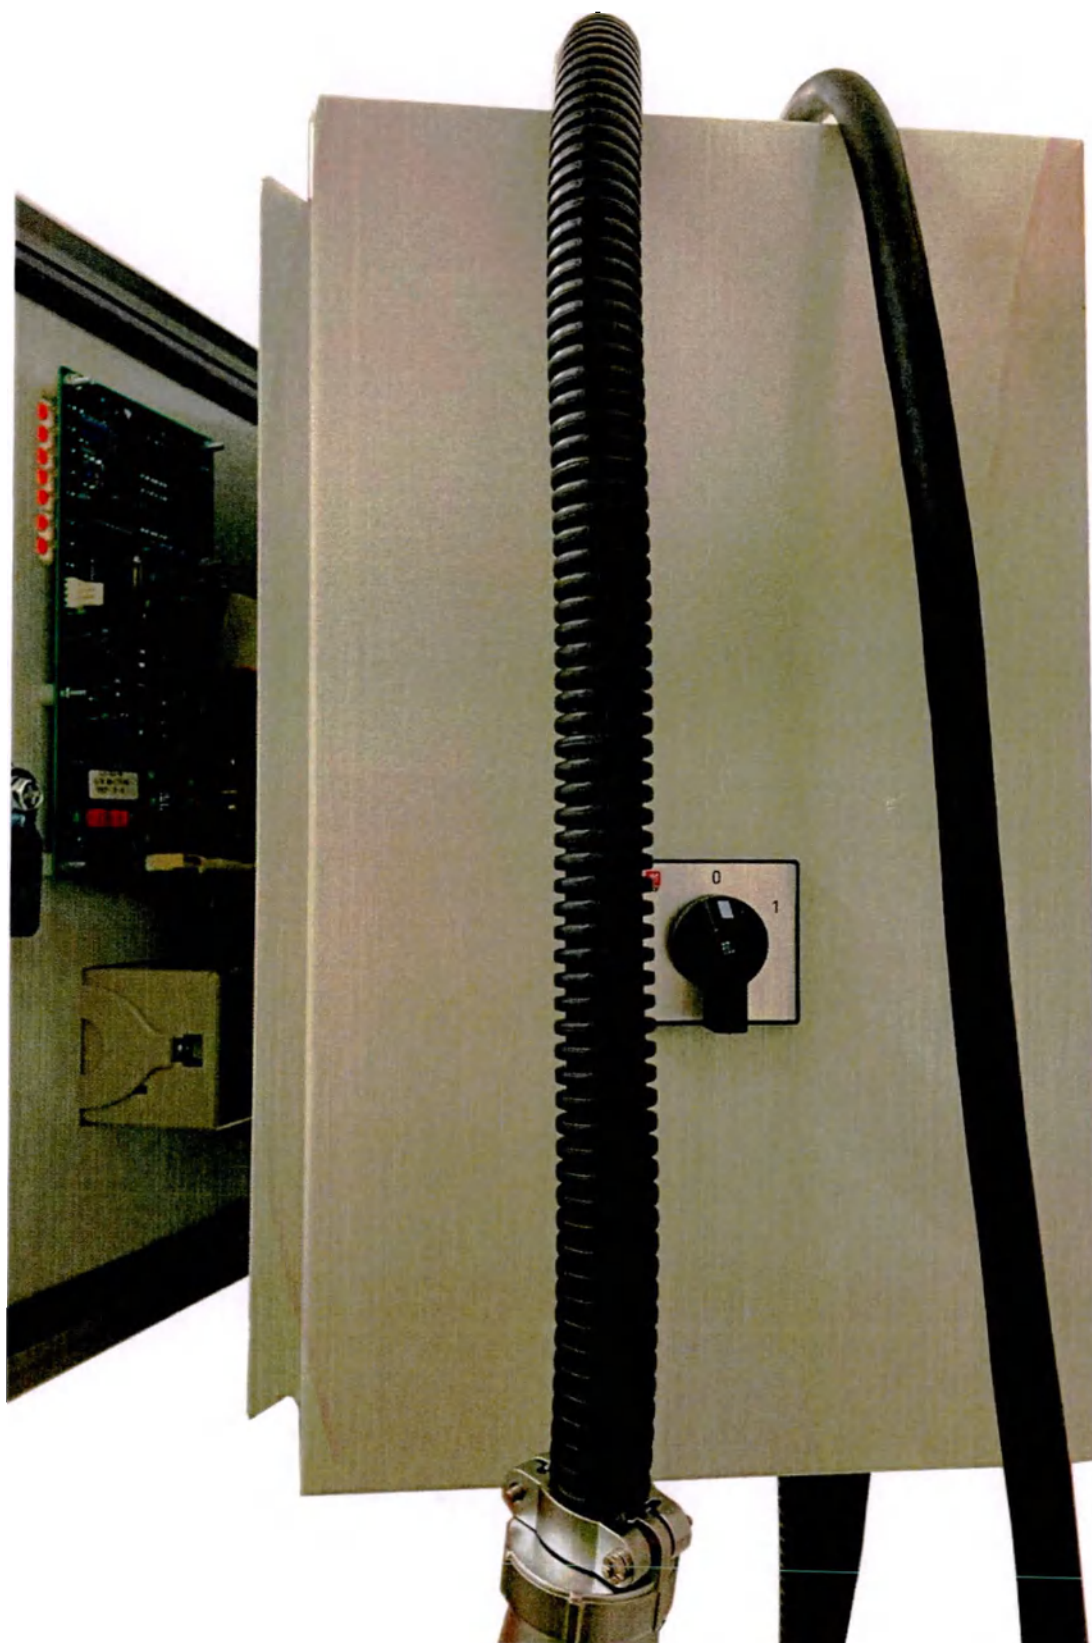

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш30 М»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш30 М»

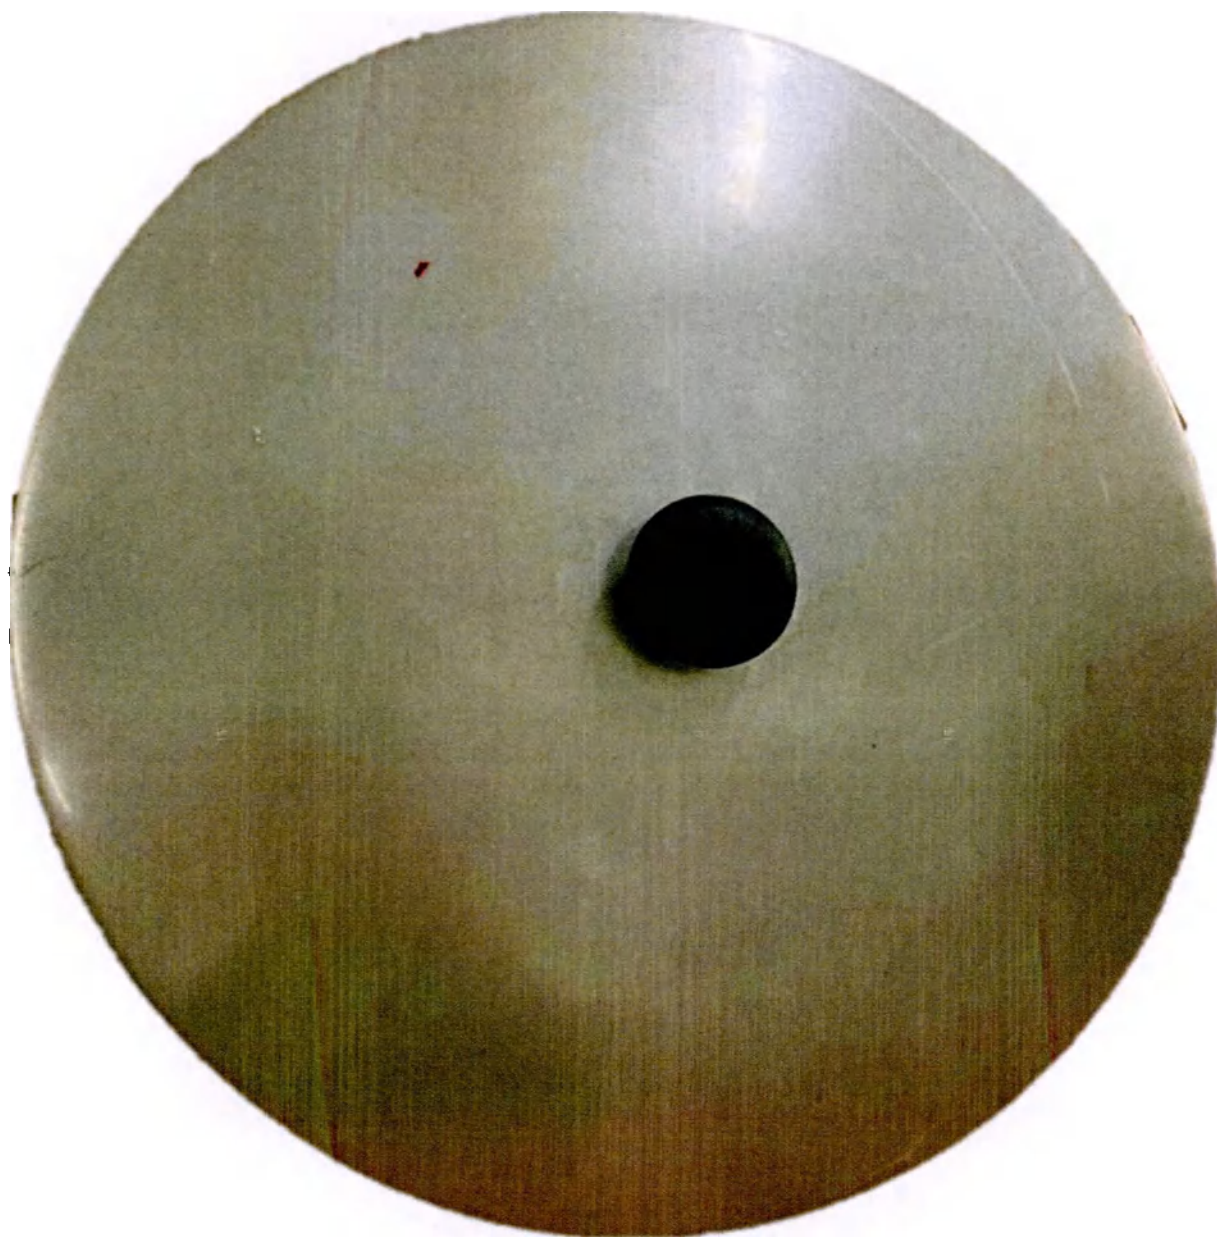

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш30 М»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



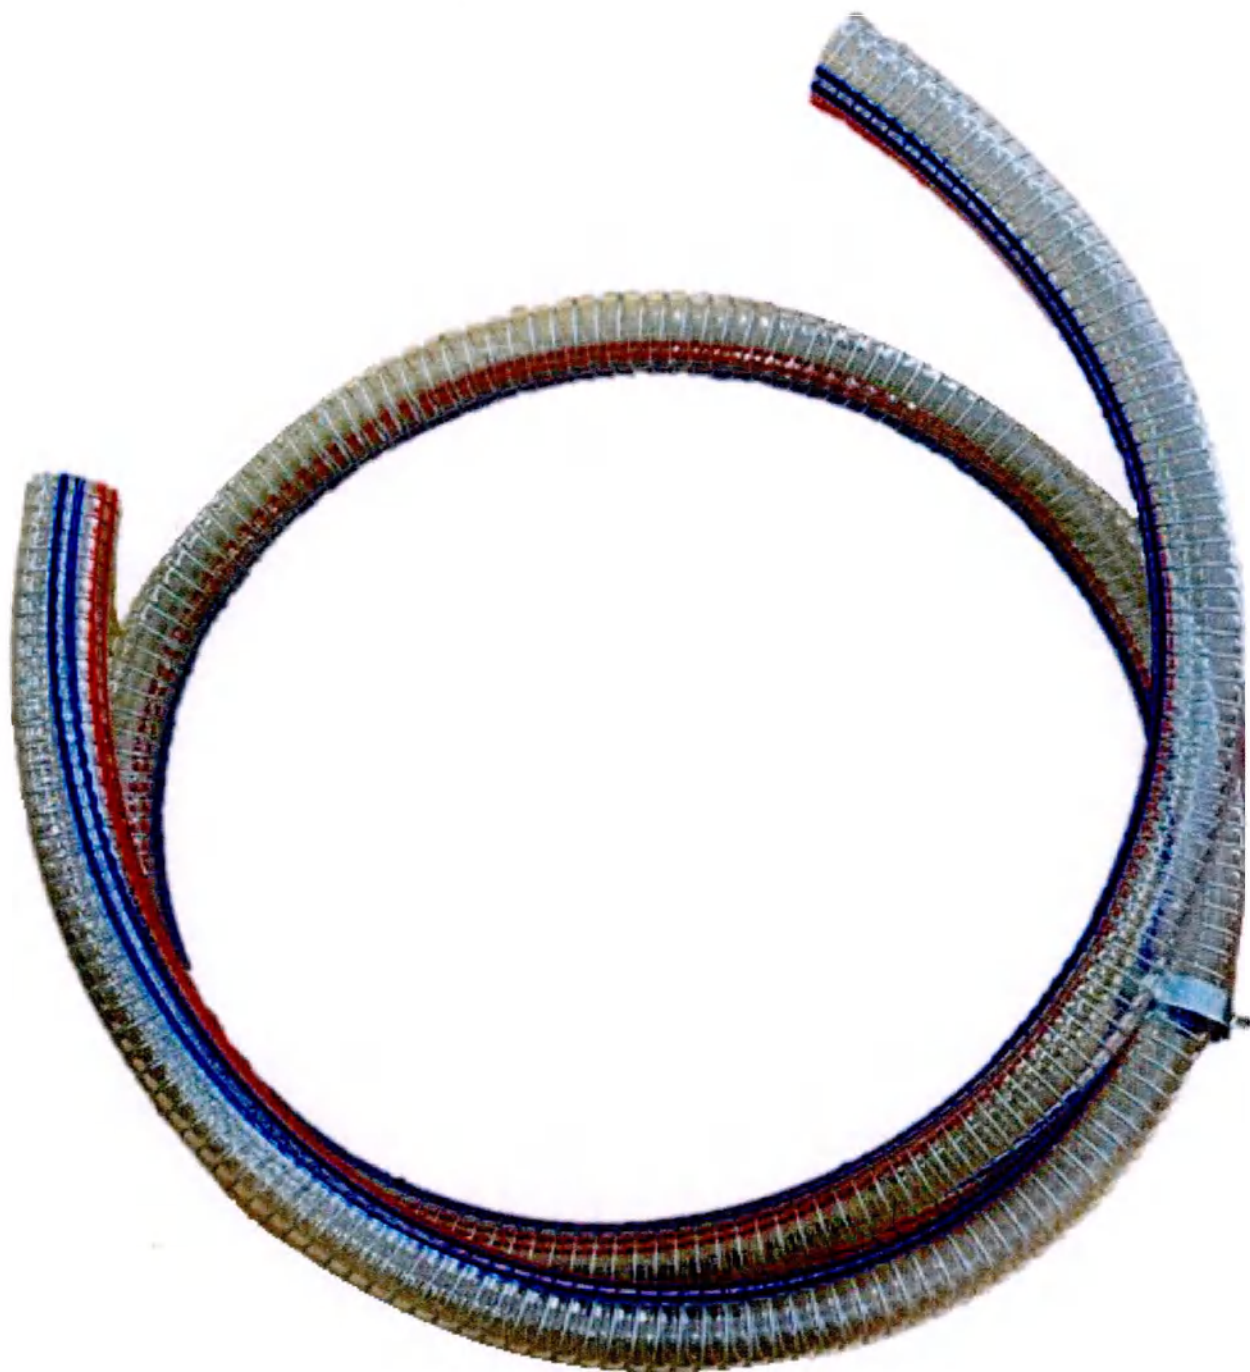

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-30

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-30

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 2,5 кВА
Объем стерилизационной камеры: 30 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.06.2023 г.
 SN 00112

    РУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Маркировка Шредер М модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер М модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3 ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА

 07.2023 г.
 SN 00112

    РУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш30 М»

**УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ**

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® - Ш30 М»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00112


3. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш50 М»

Автоклав модуль 1-50




Камера автоклава модуль 1-50

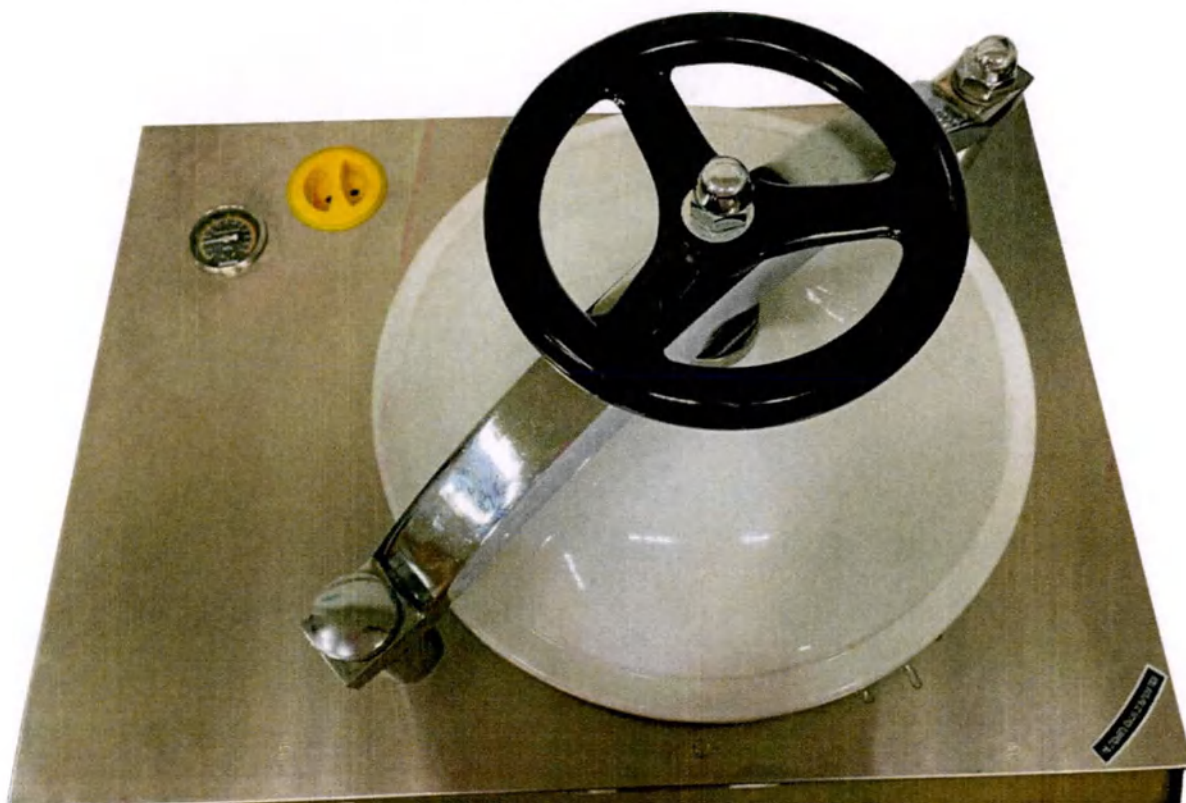

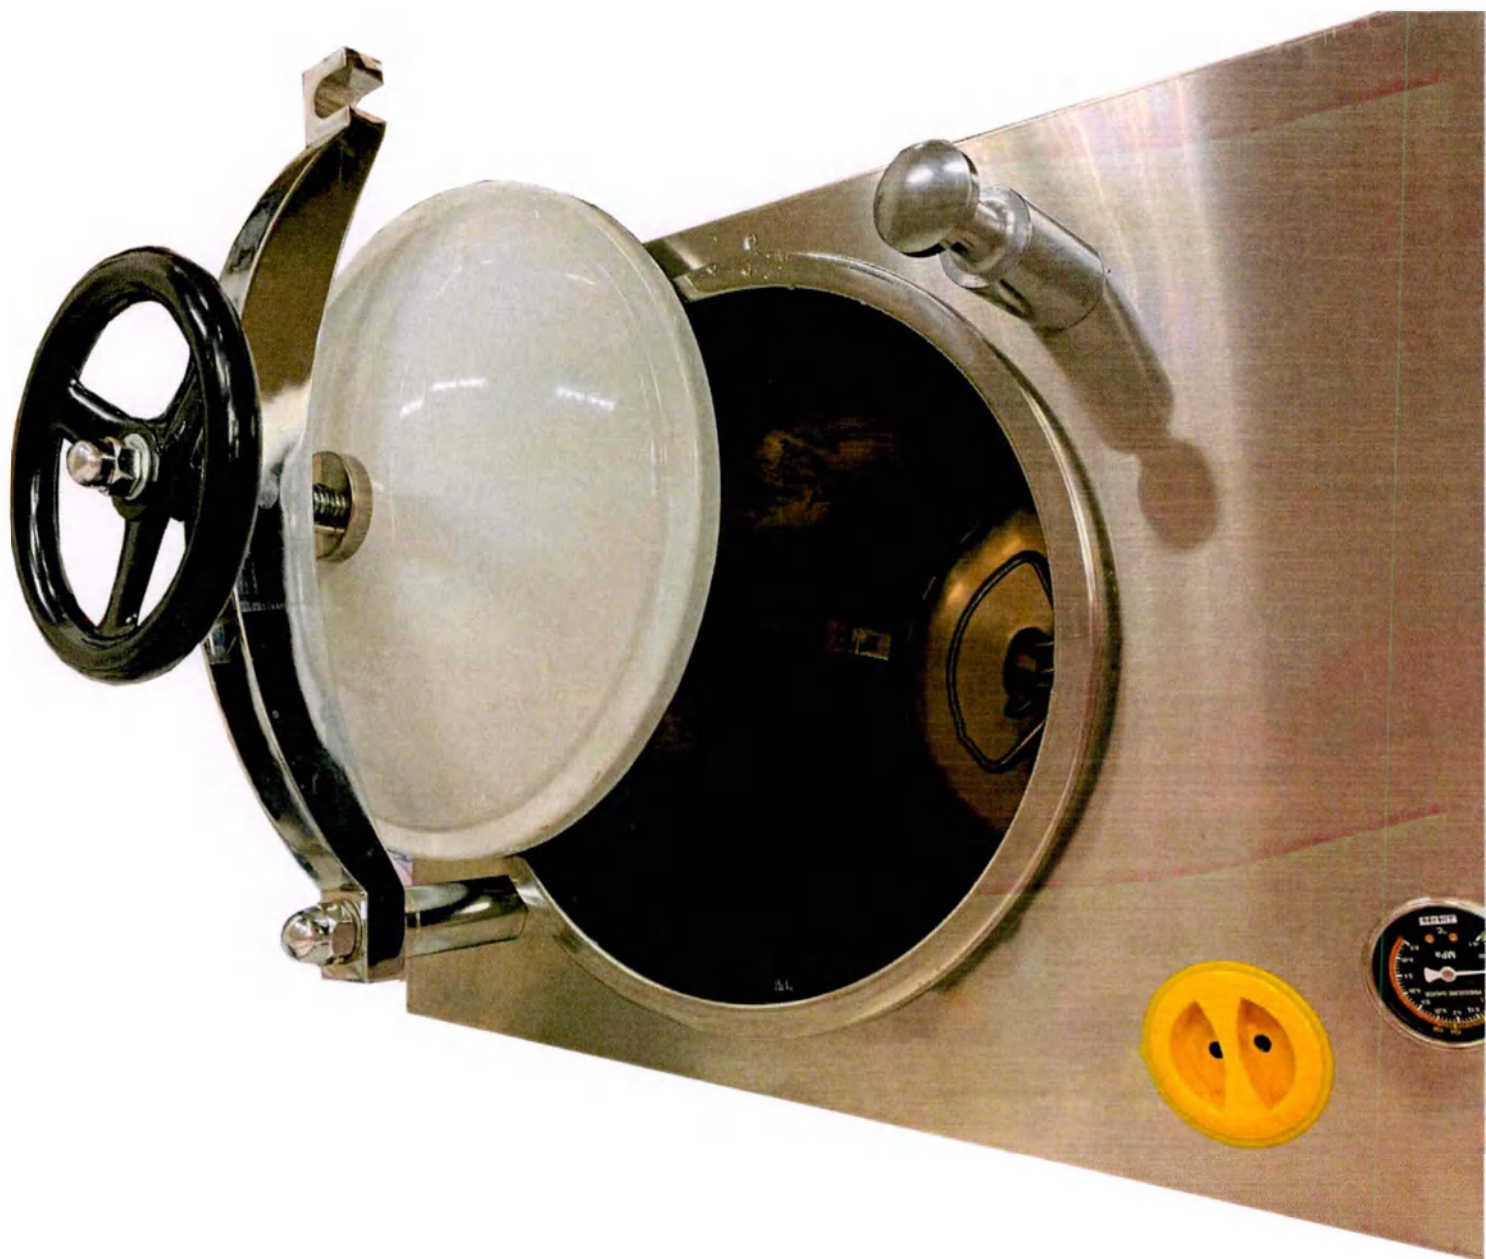



Шредер М модуль 2




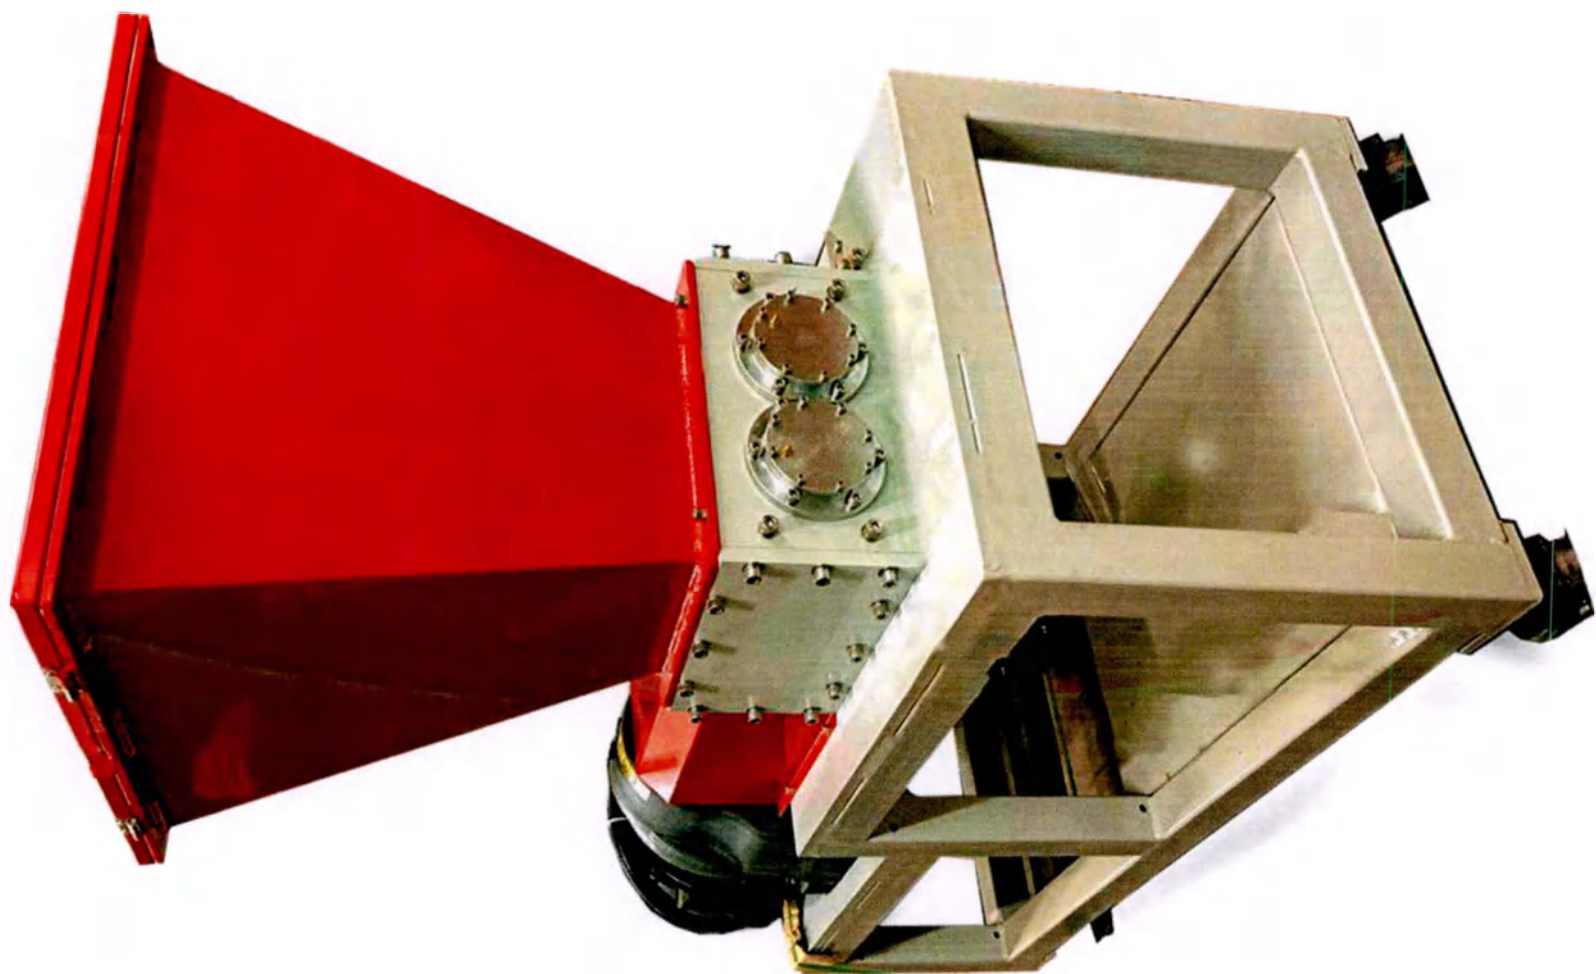



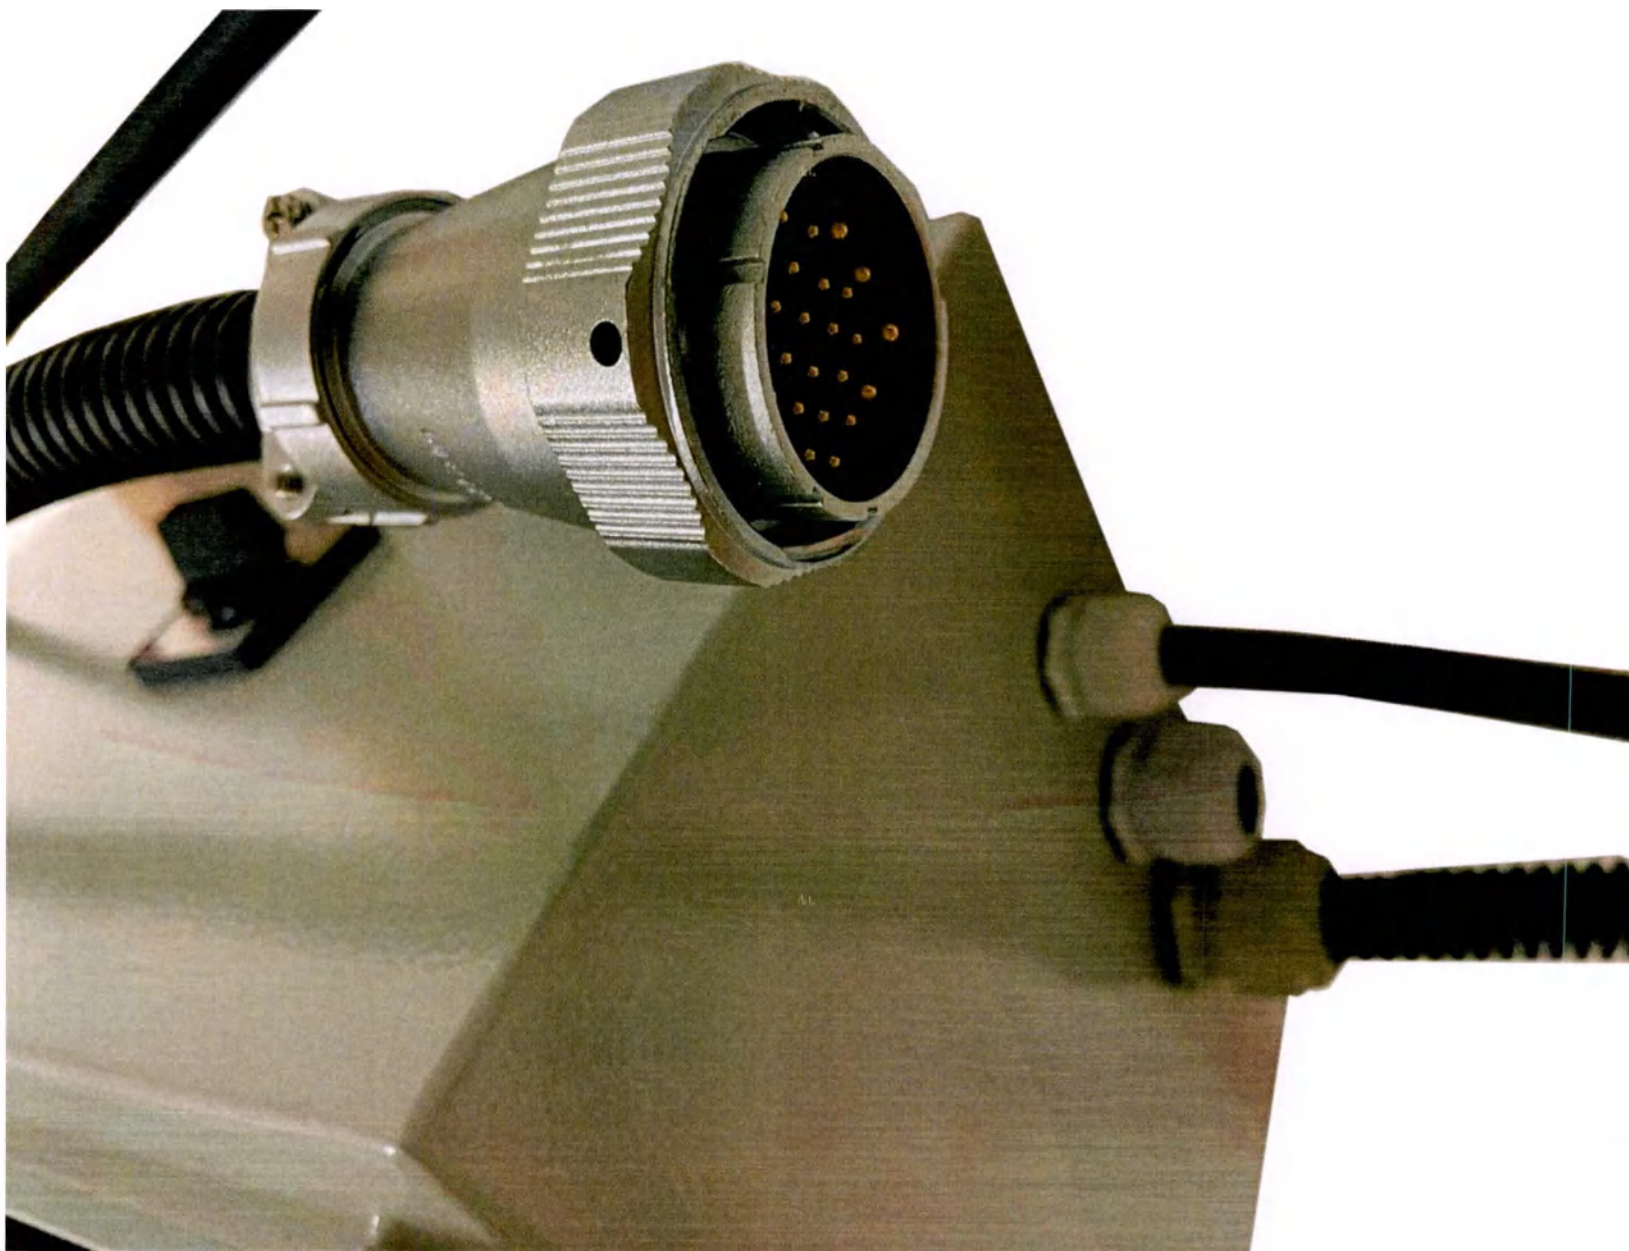

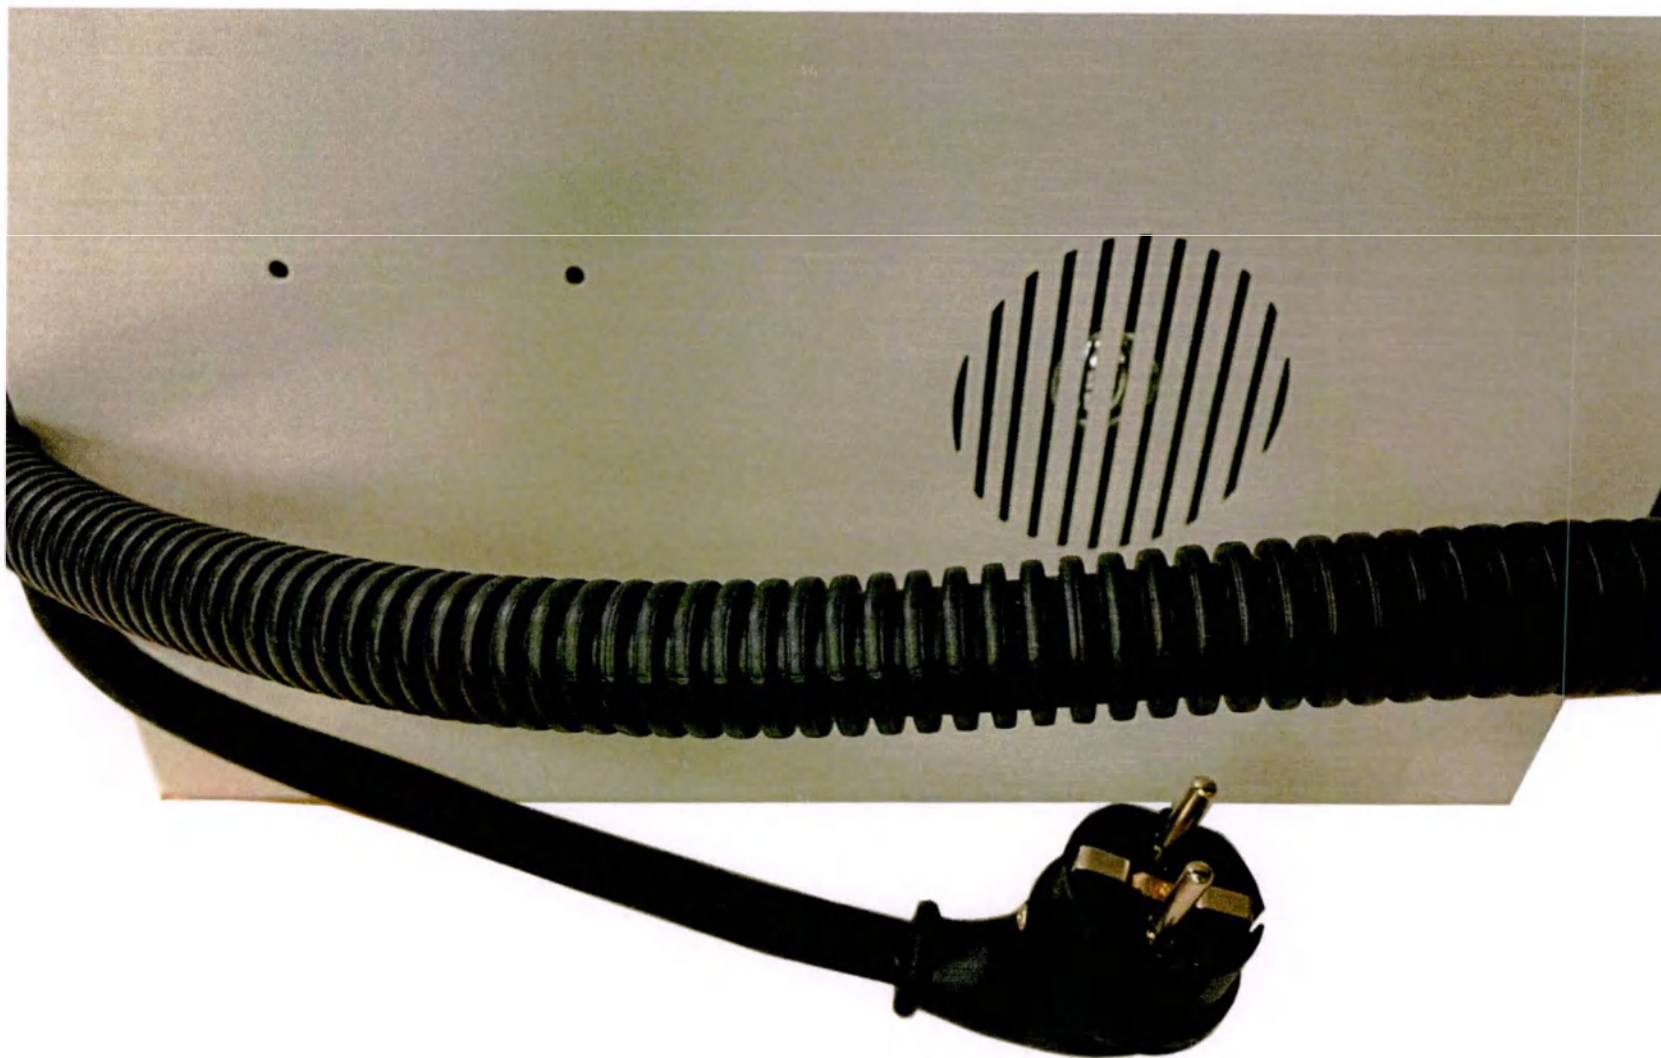


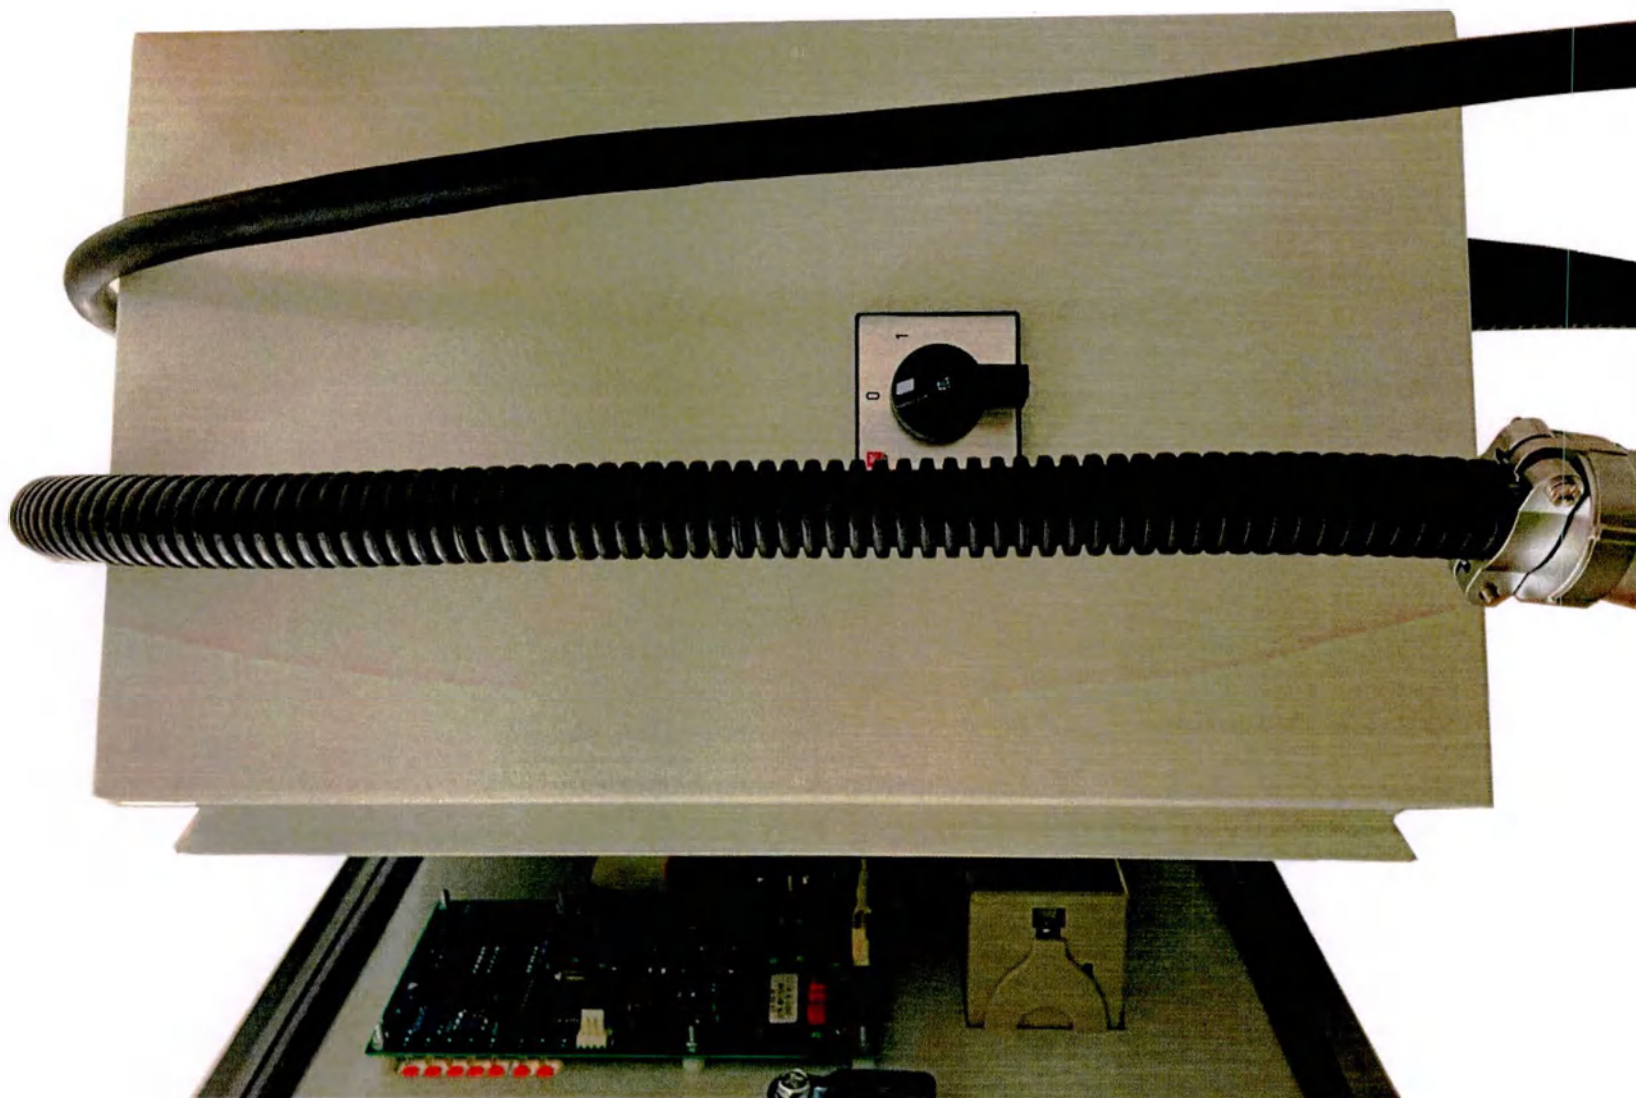

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш50 М»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш50 М»

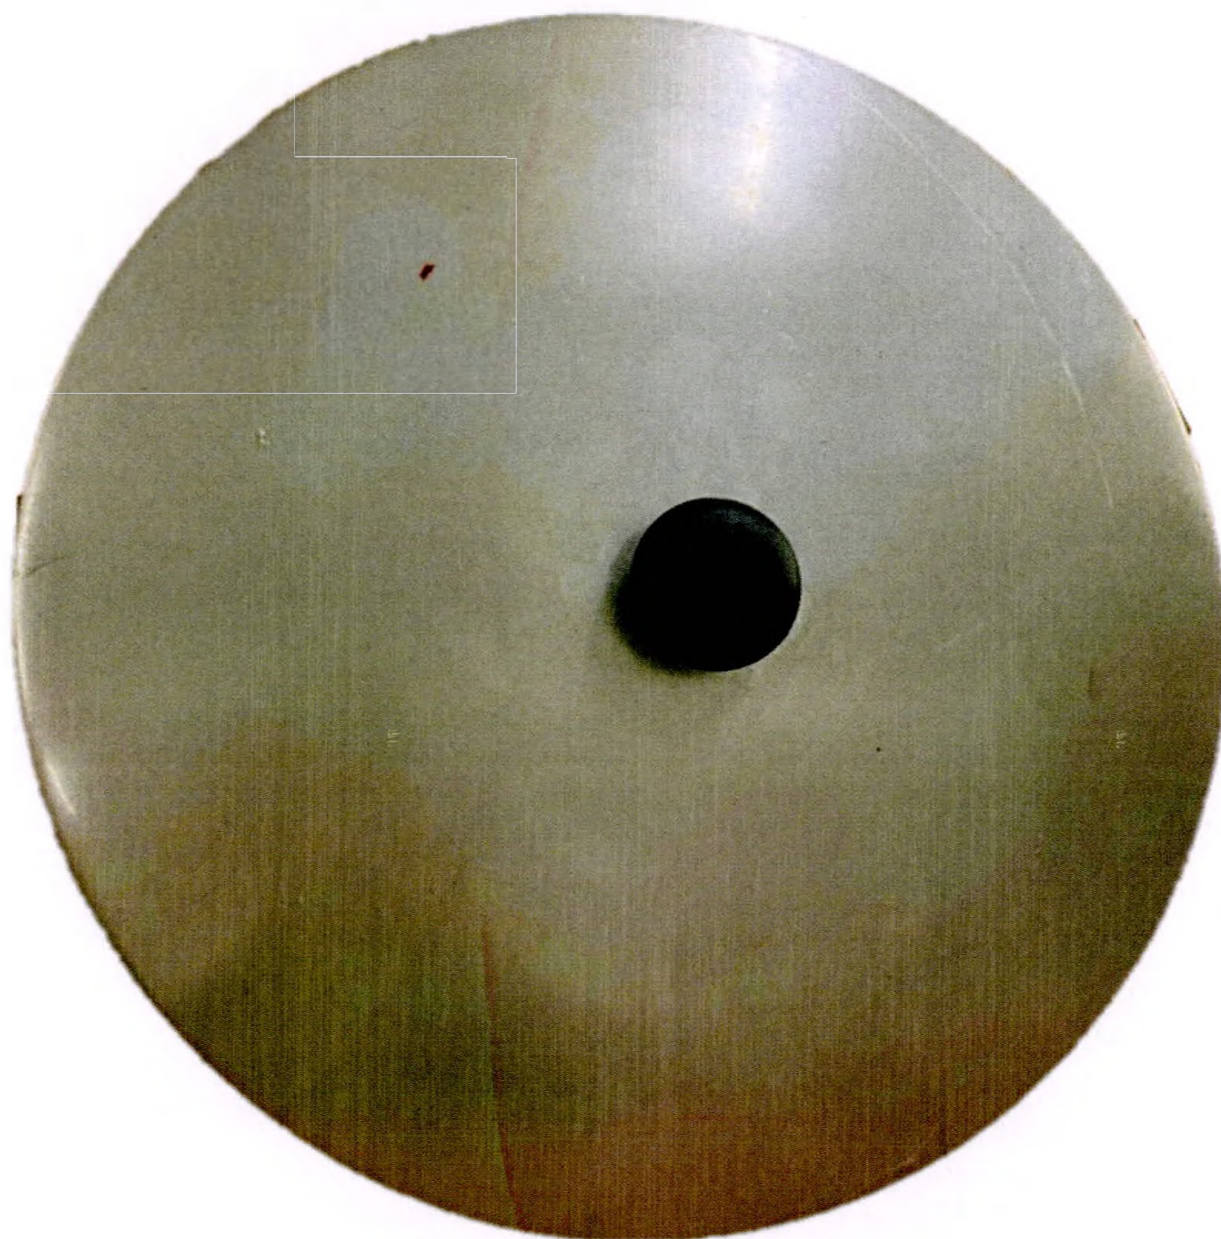


Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш50 М»





Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



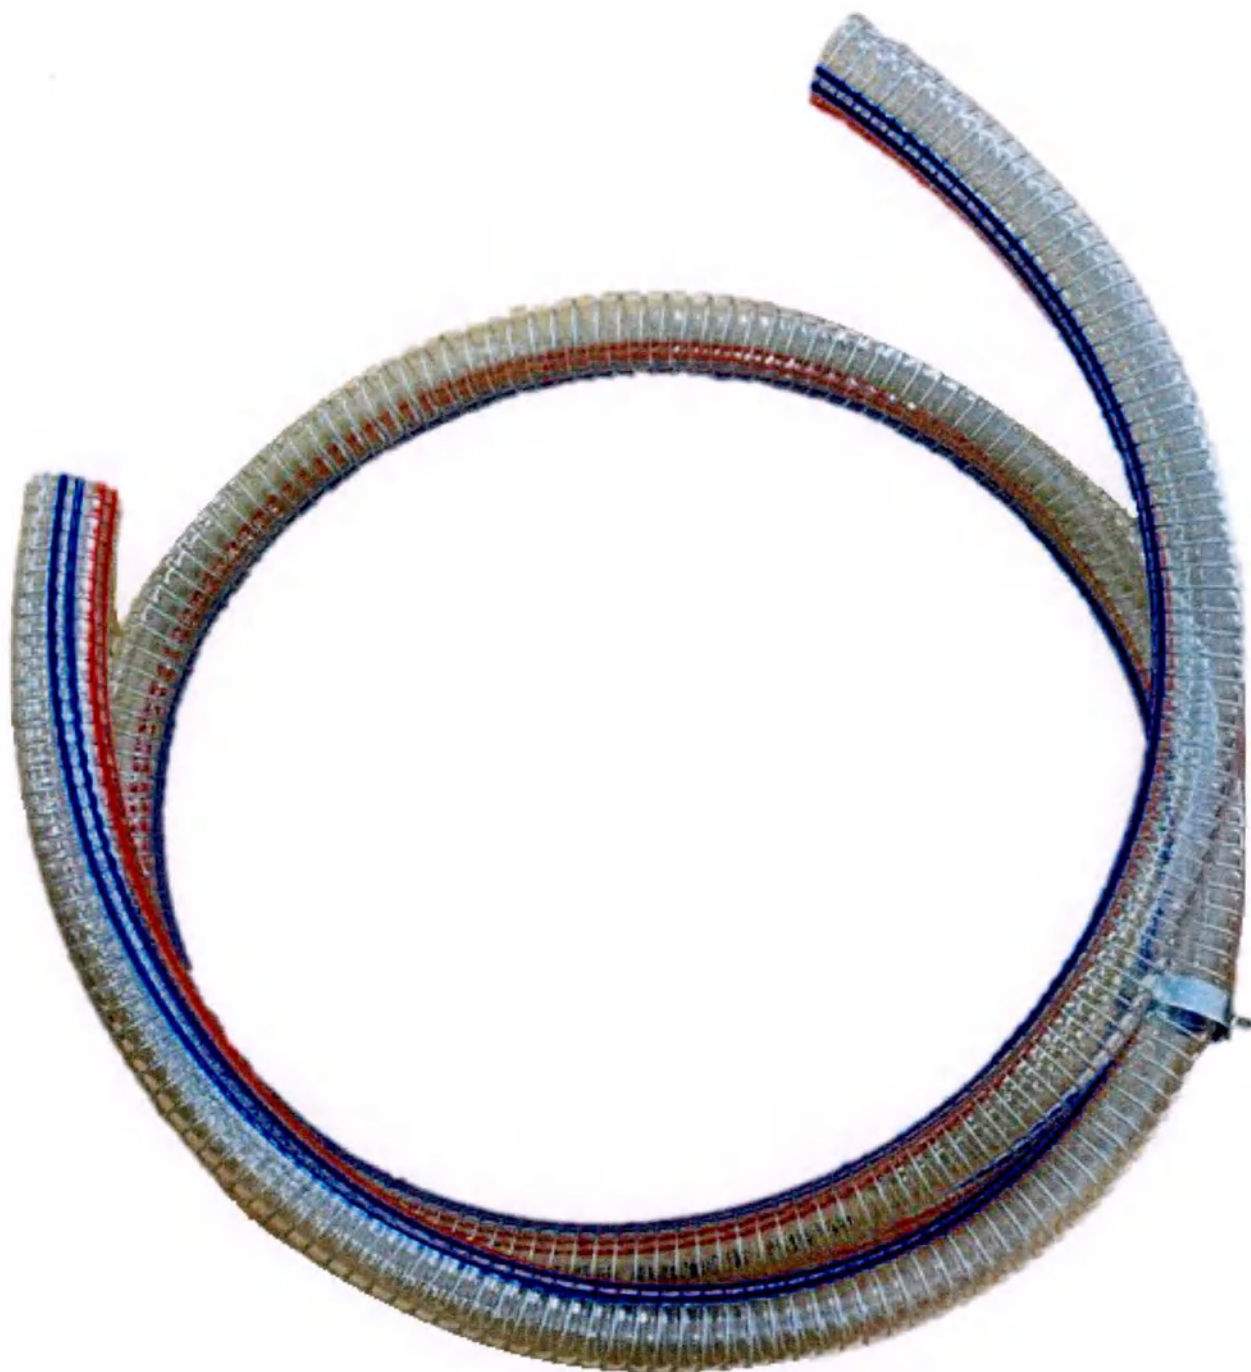

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-50

 **МЕДИТЕК®**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-50

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 50 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 SN 00111

    РУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер М модуль 2

 **МЕДИТЕК®**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер М модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА

 07.2023 г.
 SN 00111

    РУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш50 М»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш50 М»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.



00111

4. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш100/2 М».


Автоклав модуль 1-50




Автоклав модуль 1-50




Камера автоклава модуль 1-50

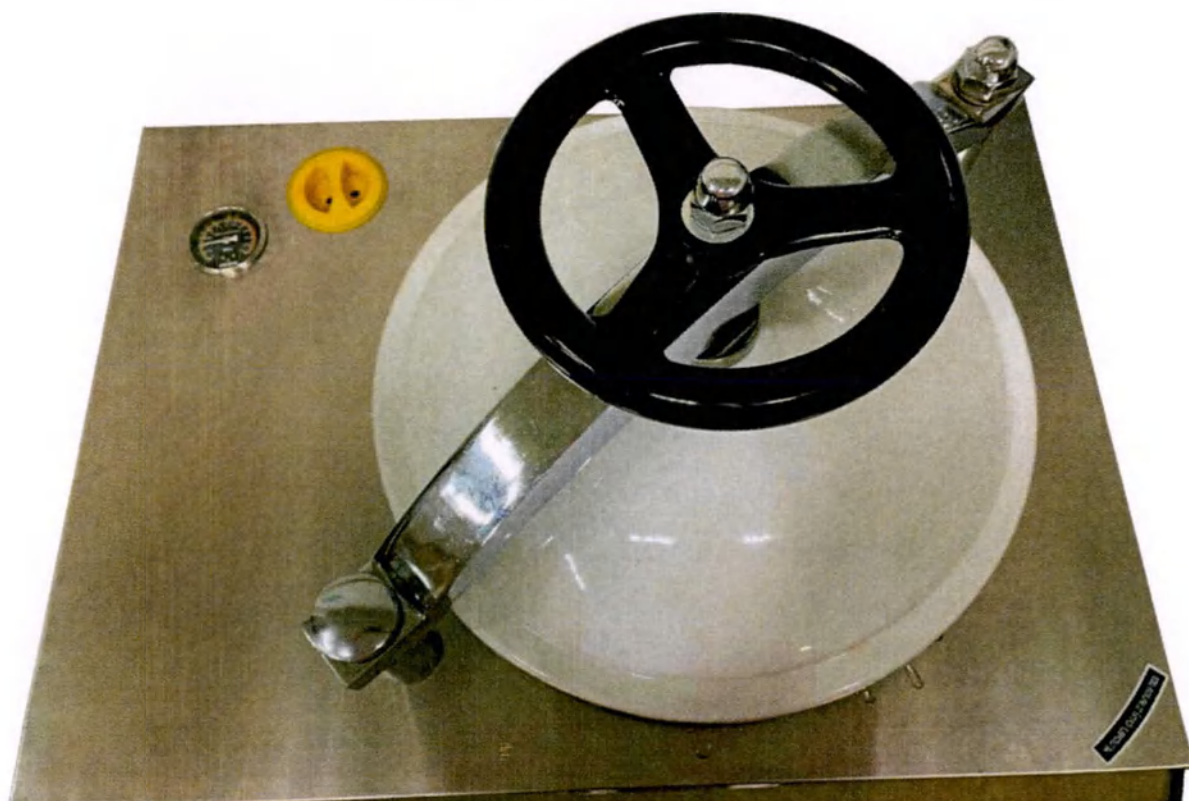


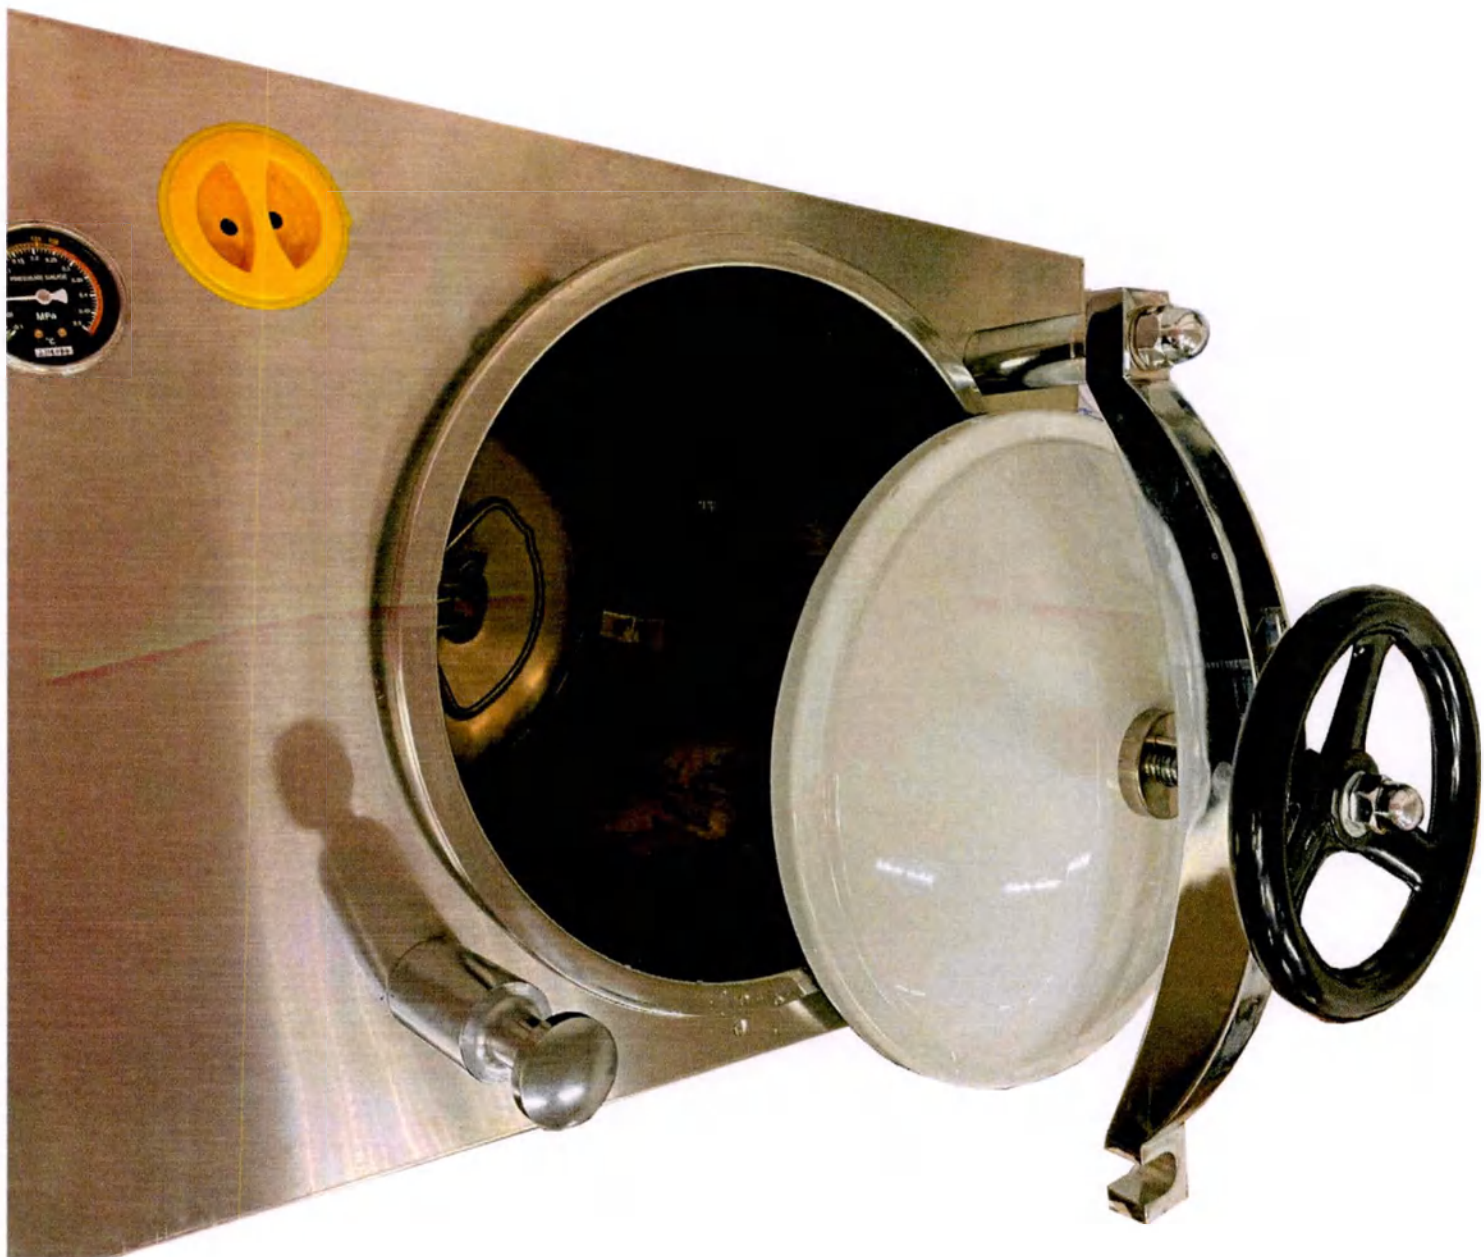



Шредер М модуль 2




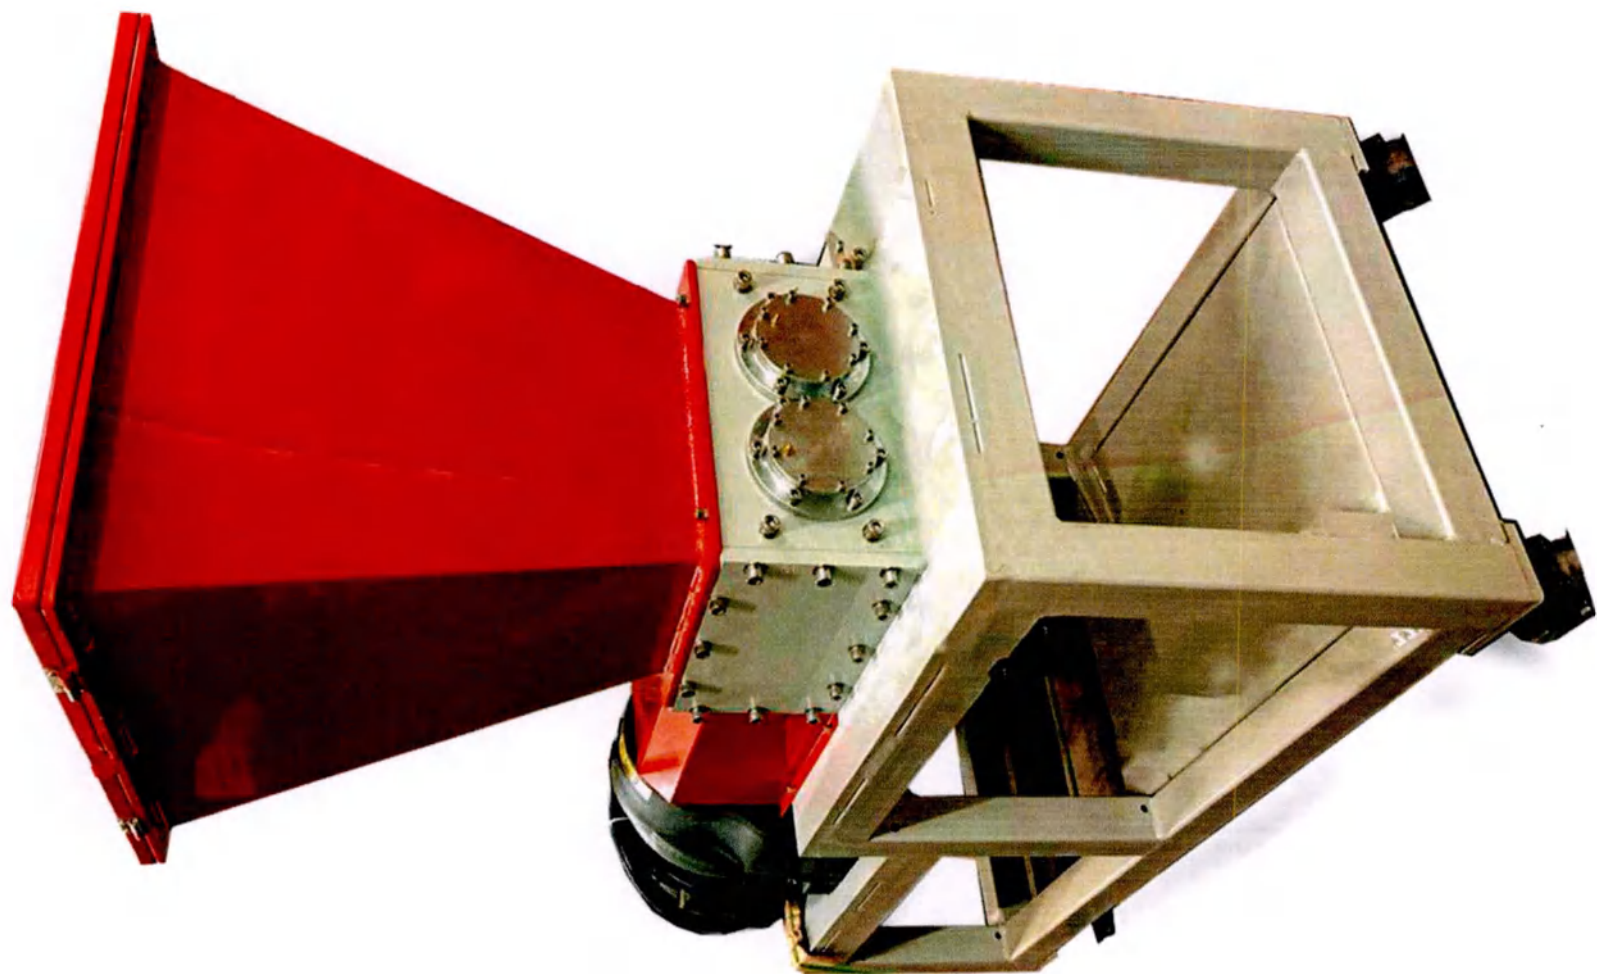

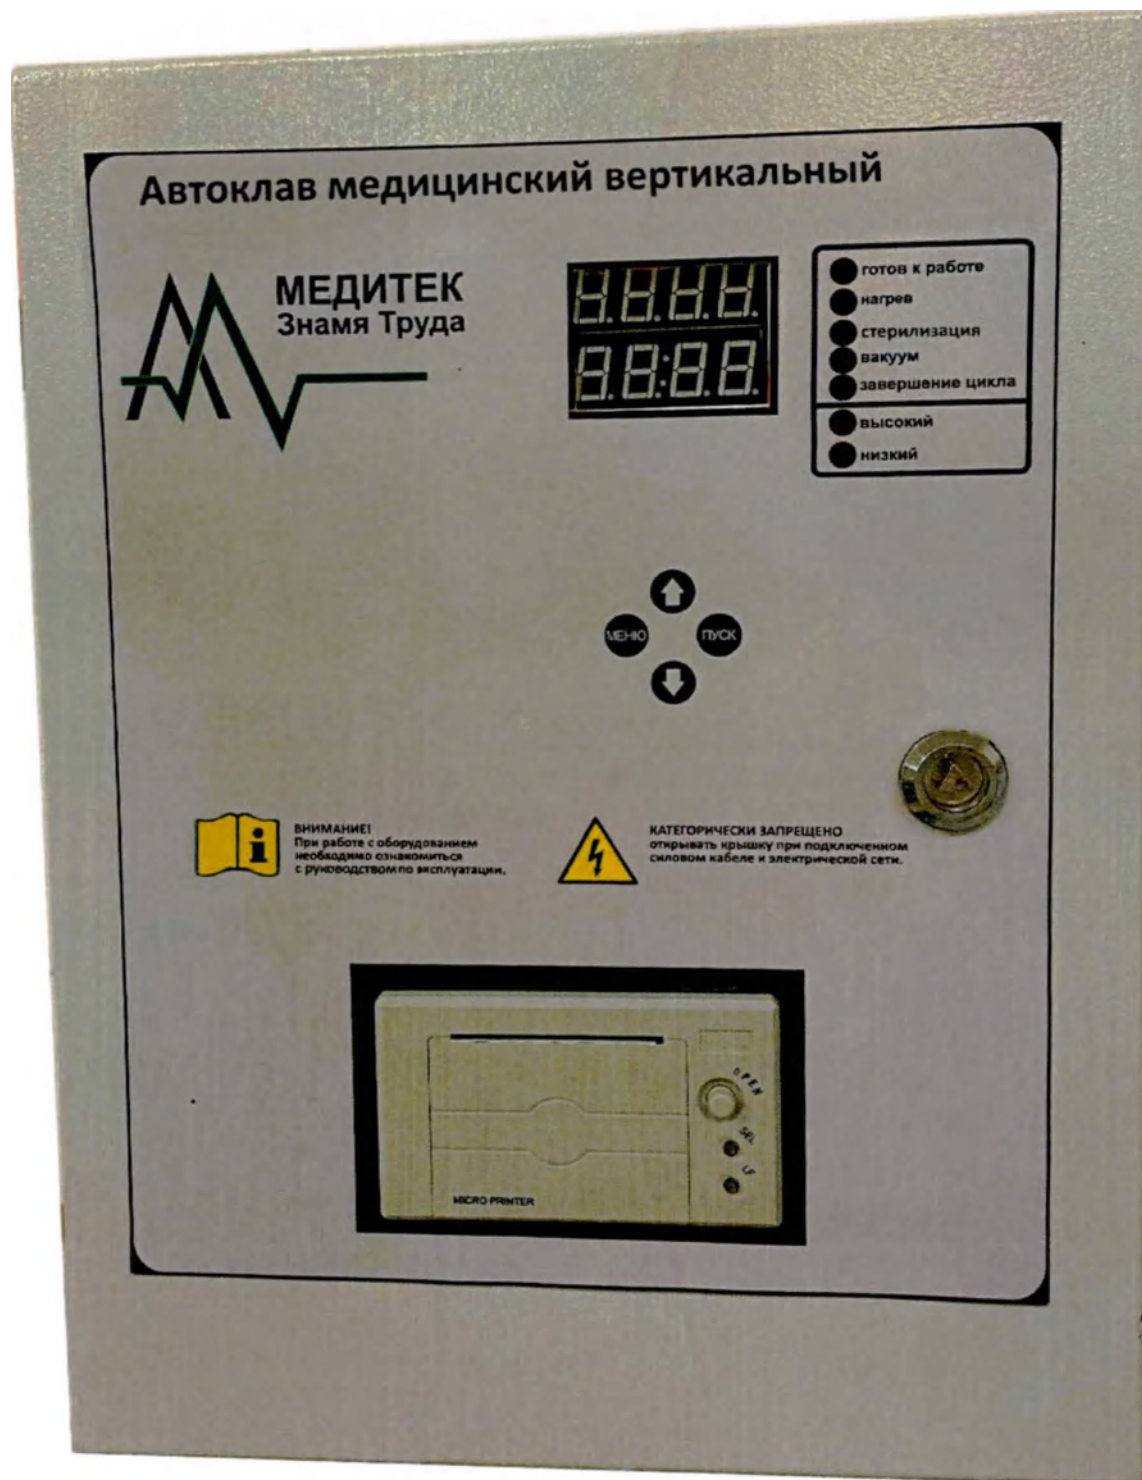

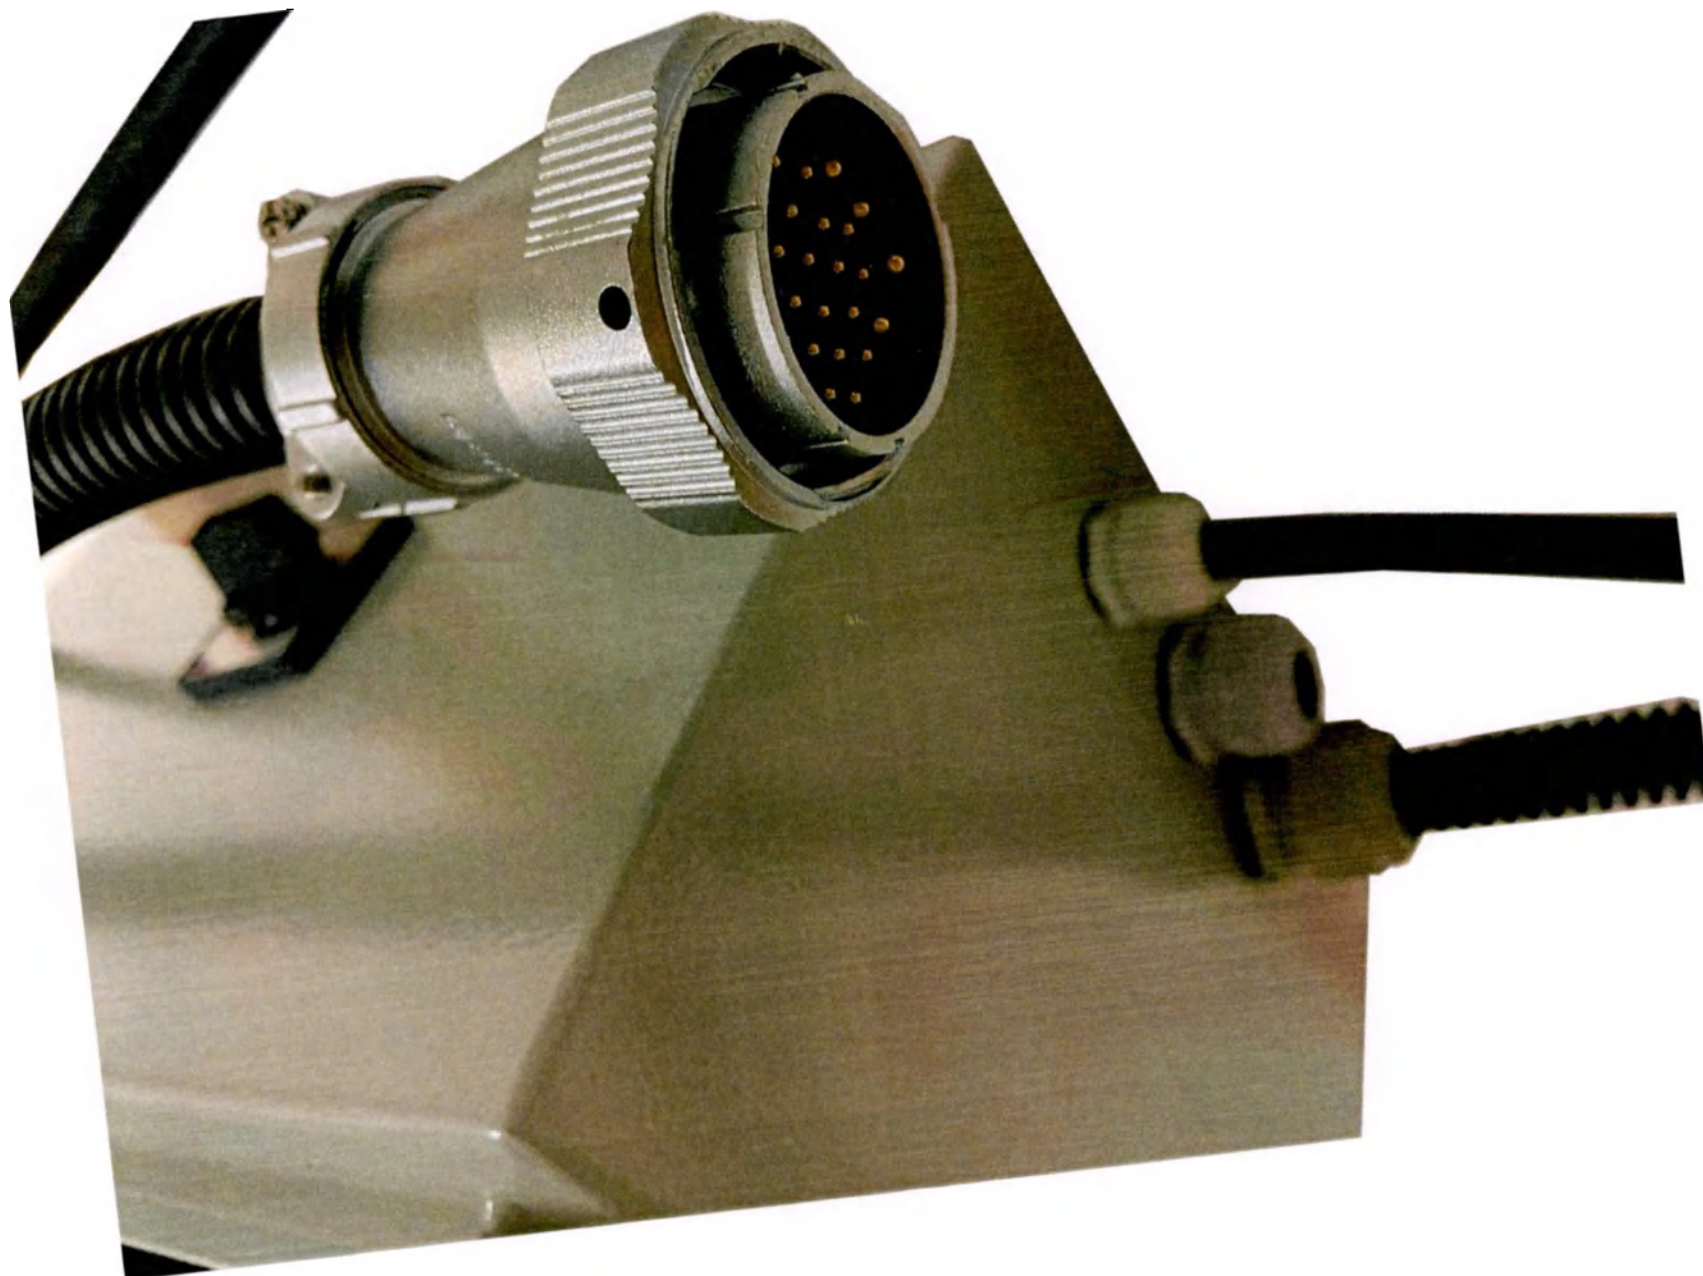

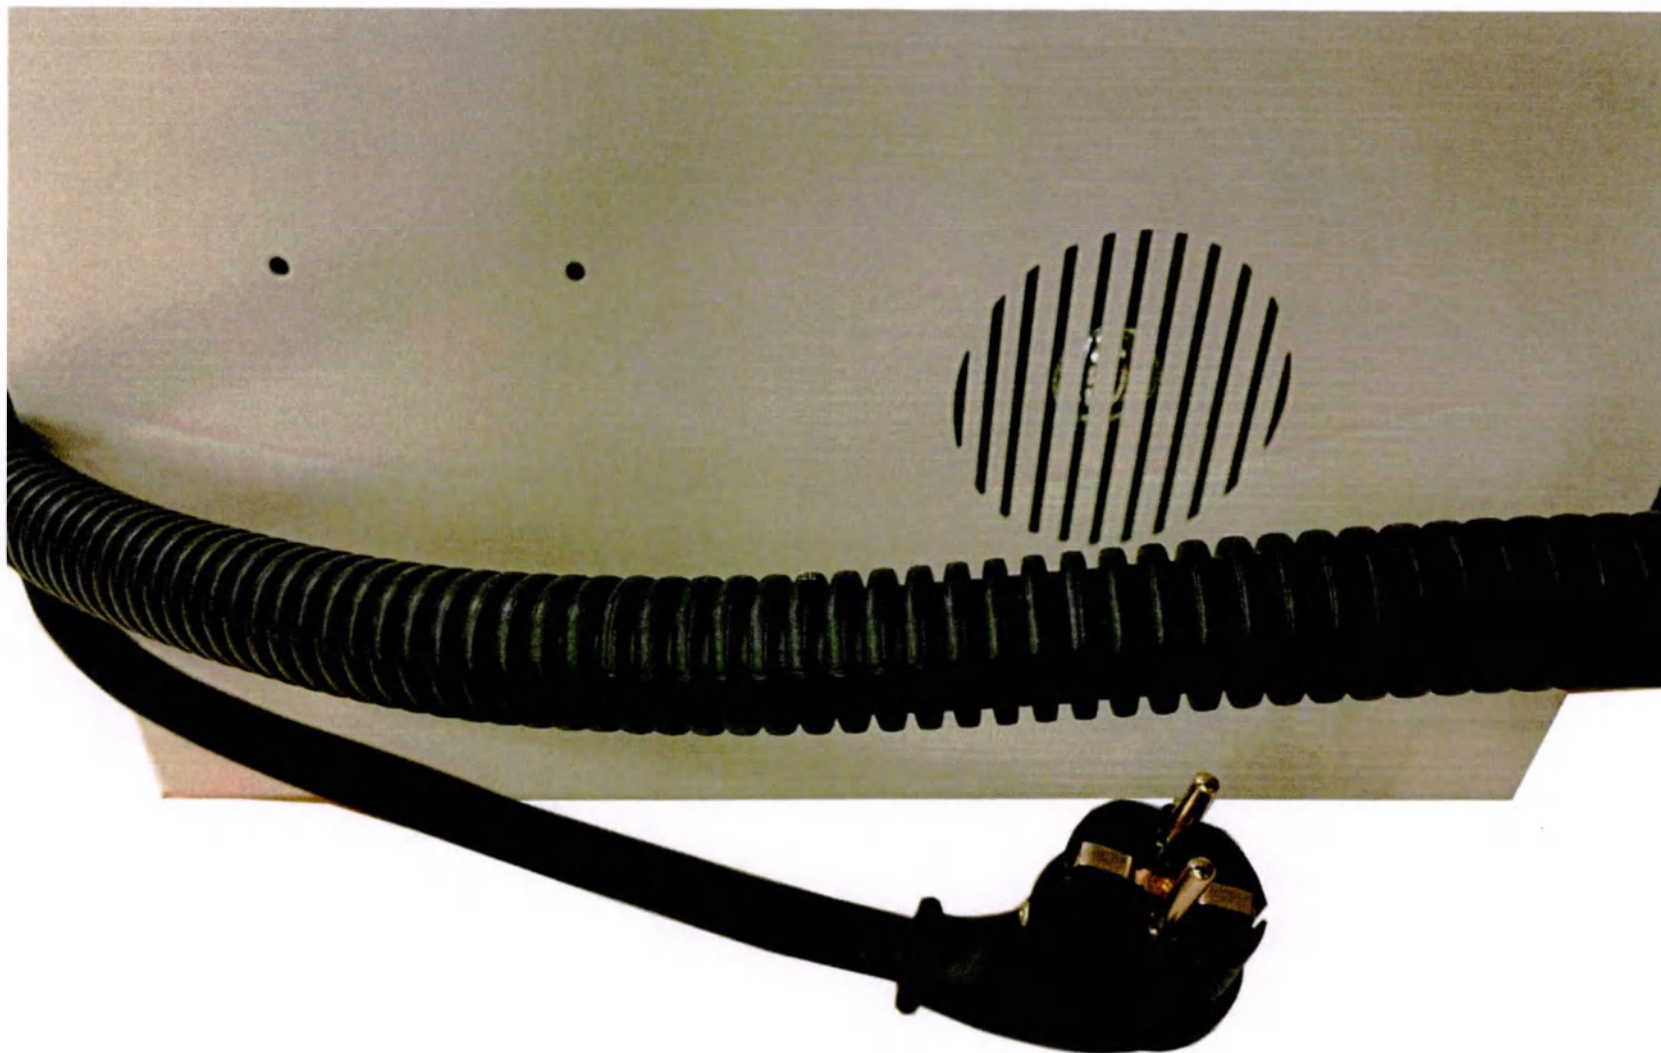


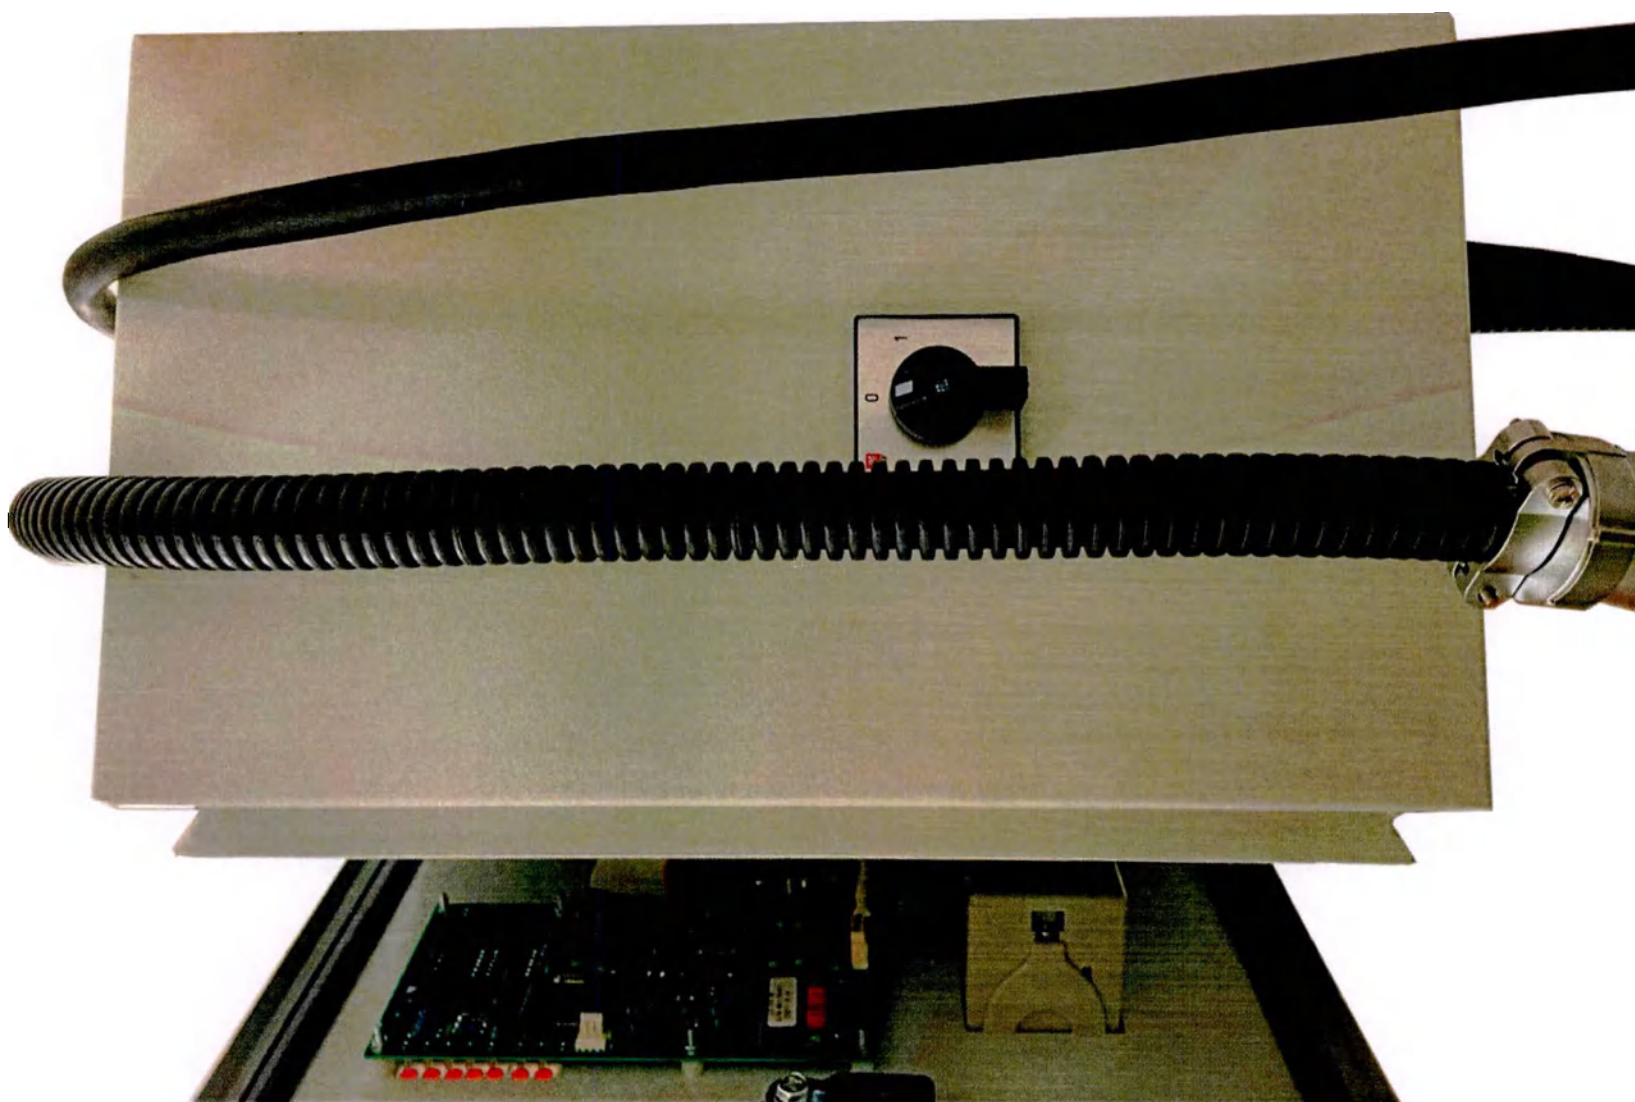

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш100/2 М»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100/2 М»

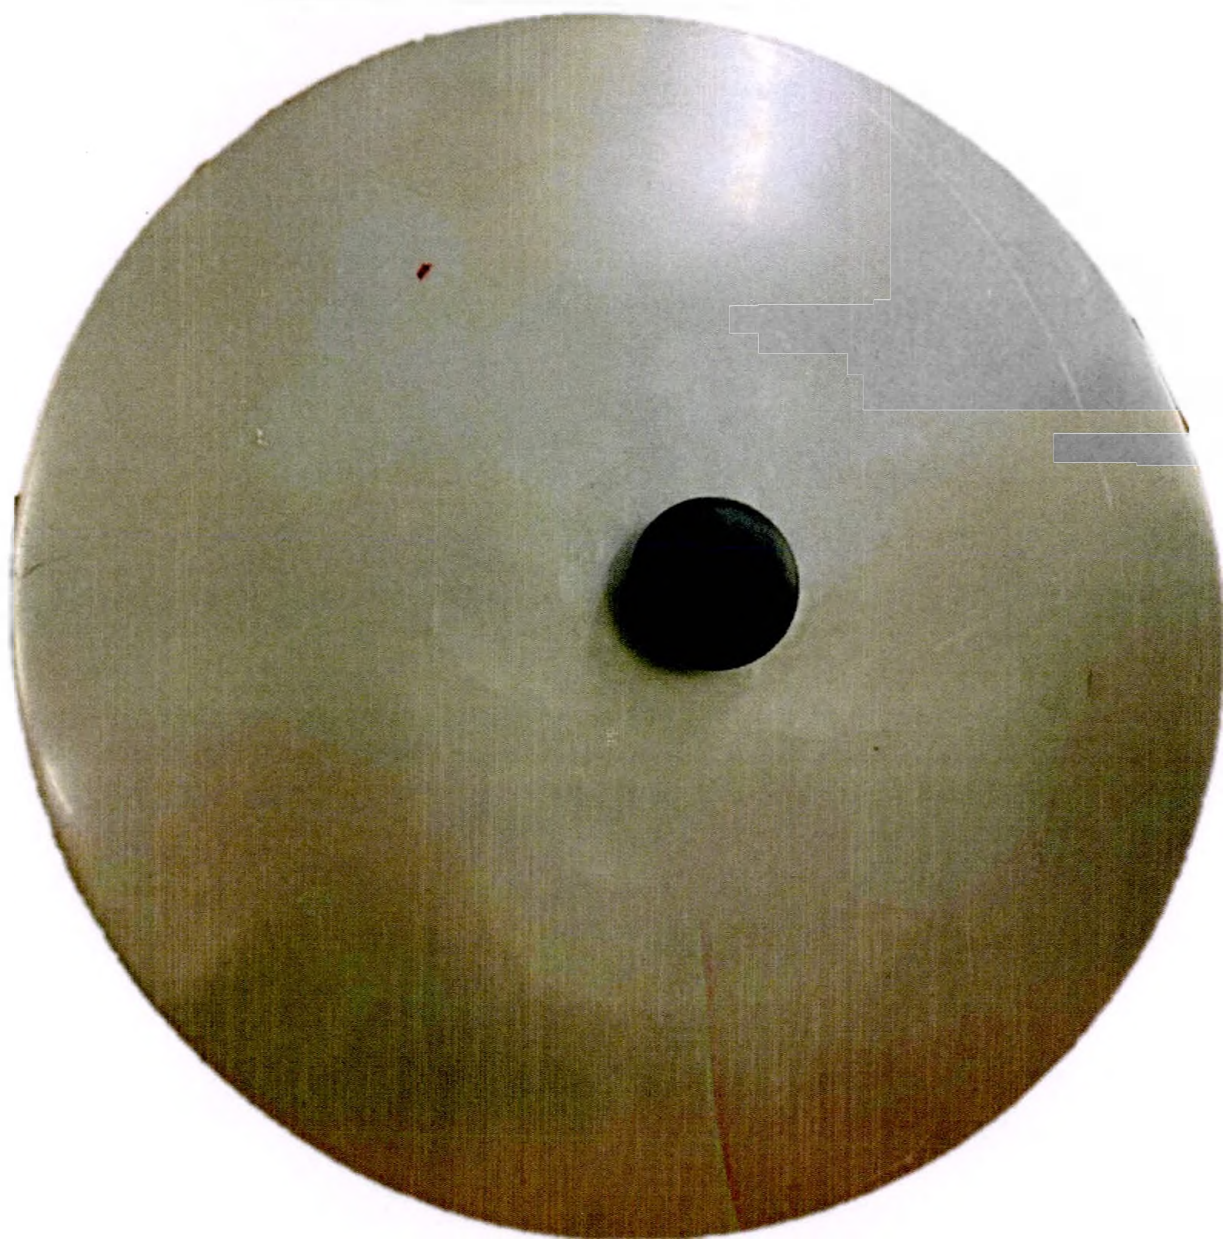




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



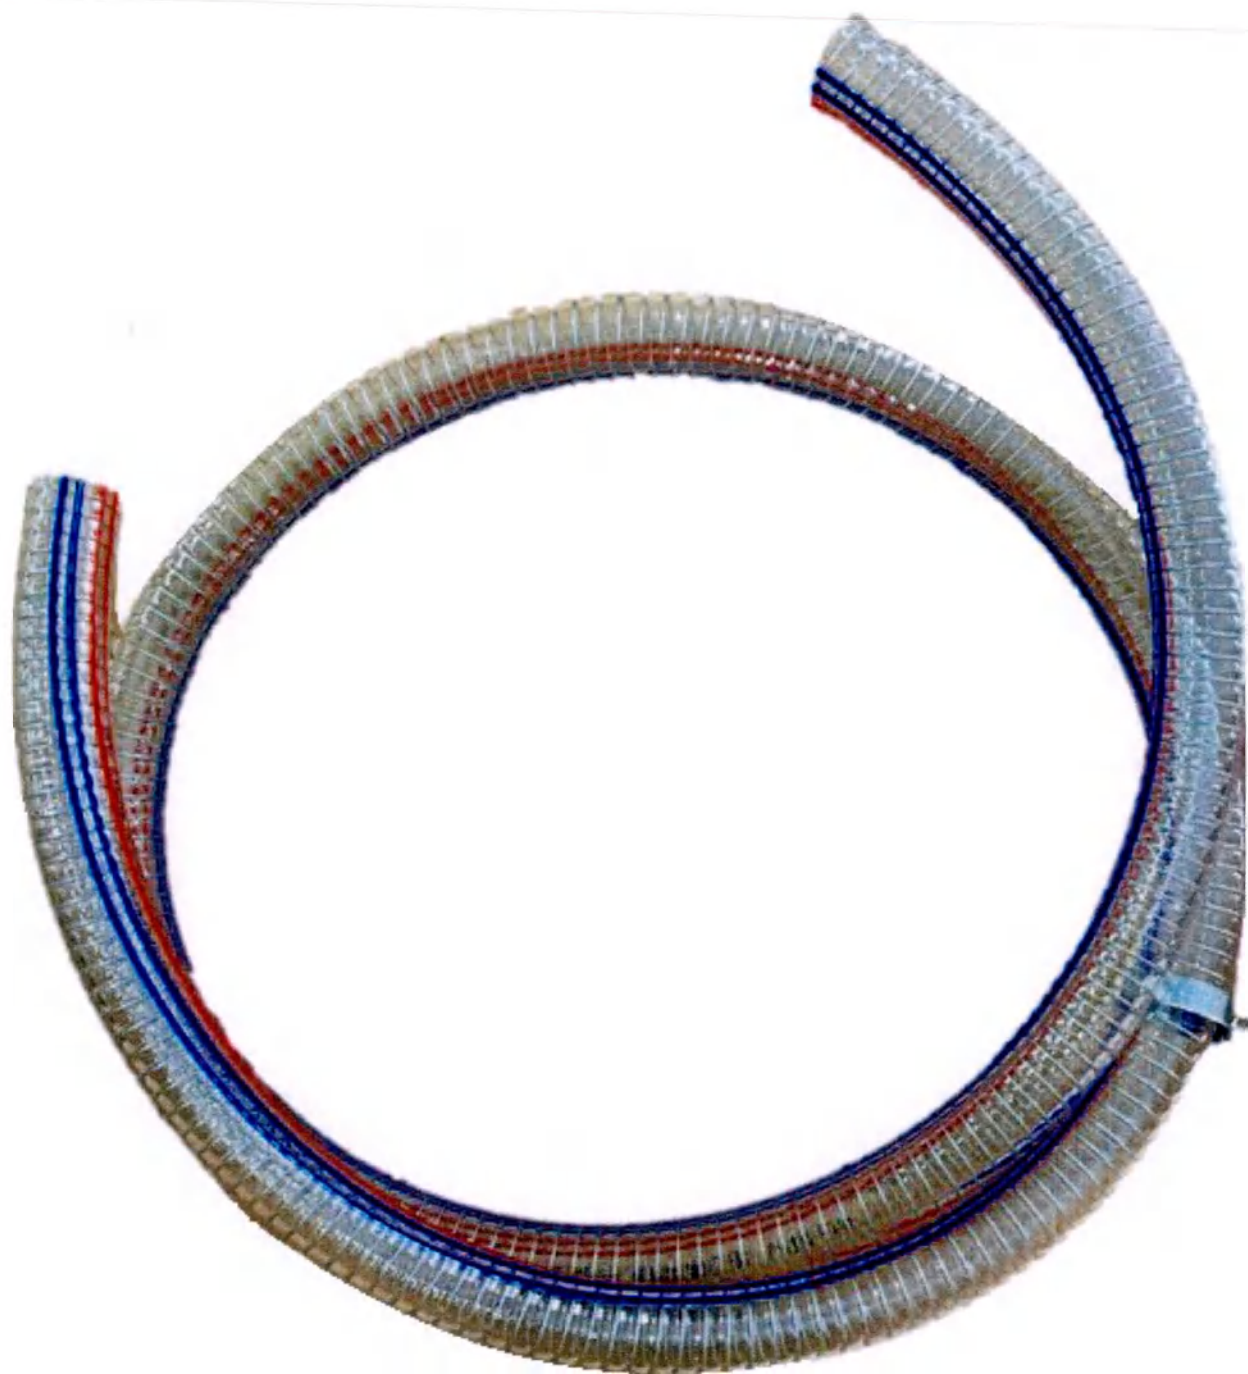

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-50

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-50

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 50 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

07.06.2023 г.

SN 00114/1

ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Автоклав модуль 1-50

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-50

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru


Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 50 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

07.2023 г.

SN 00114/2

ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер М модуль 2

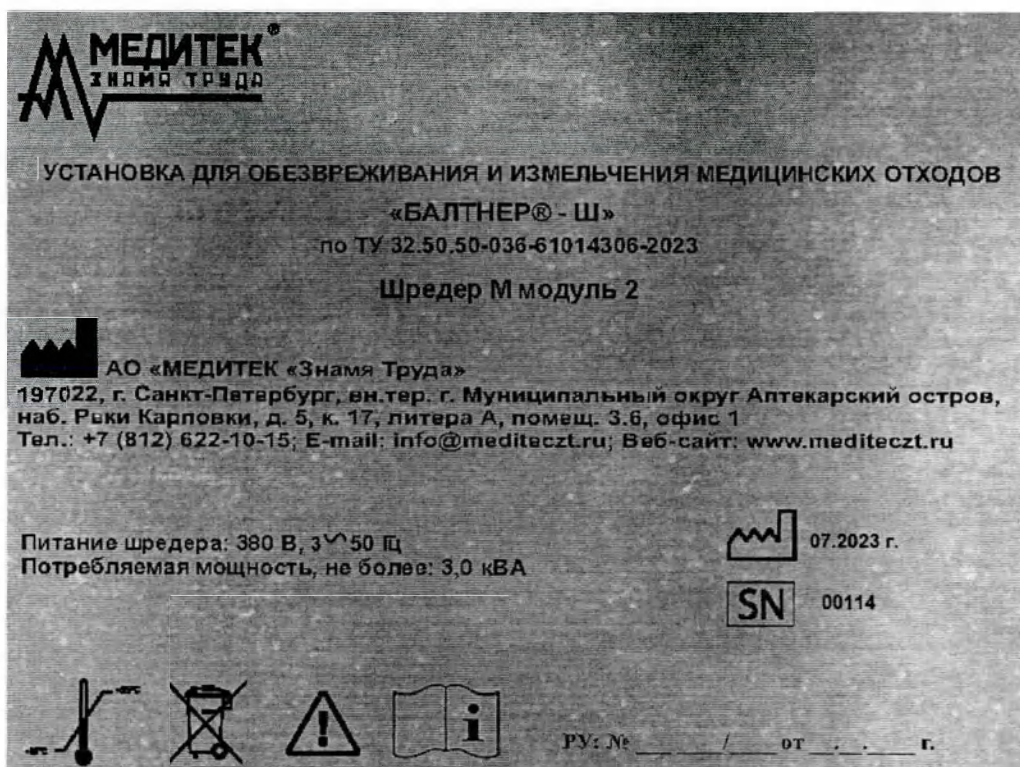

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш100/2 М»




5. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш100 М»

Автоклав модуль 1-100





Камера автоклава модуль 1-100




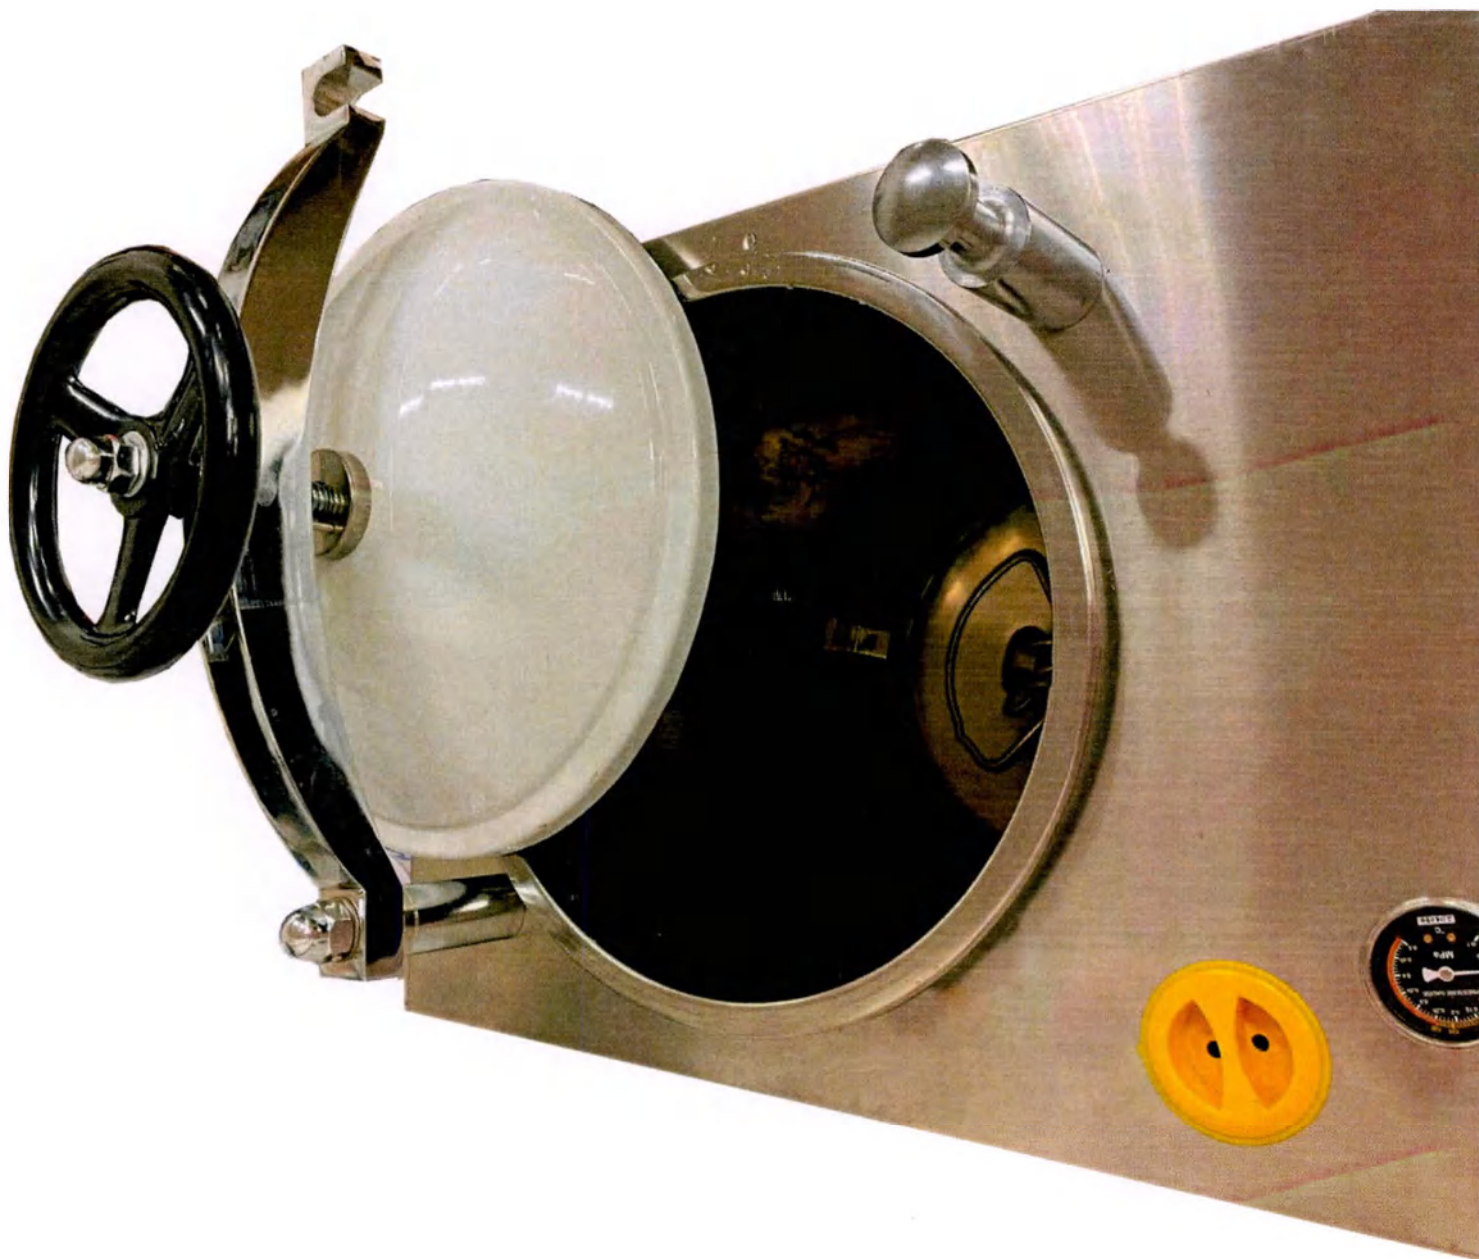





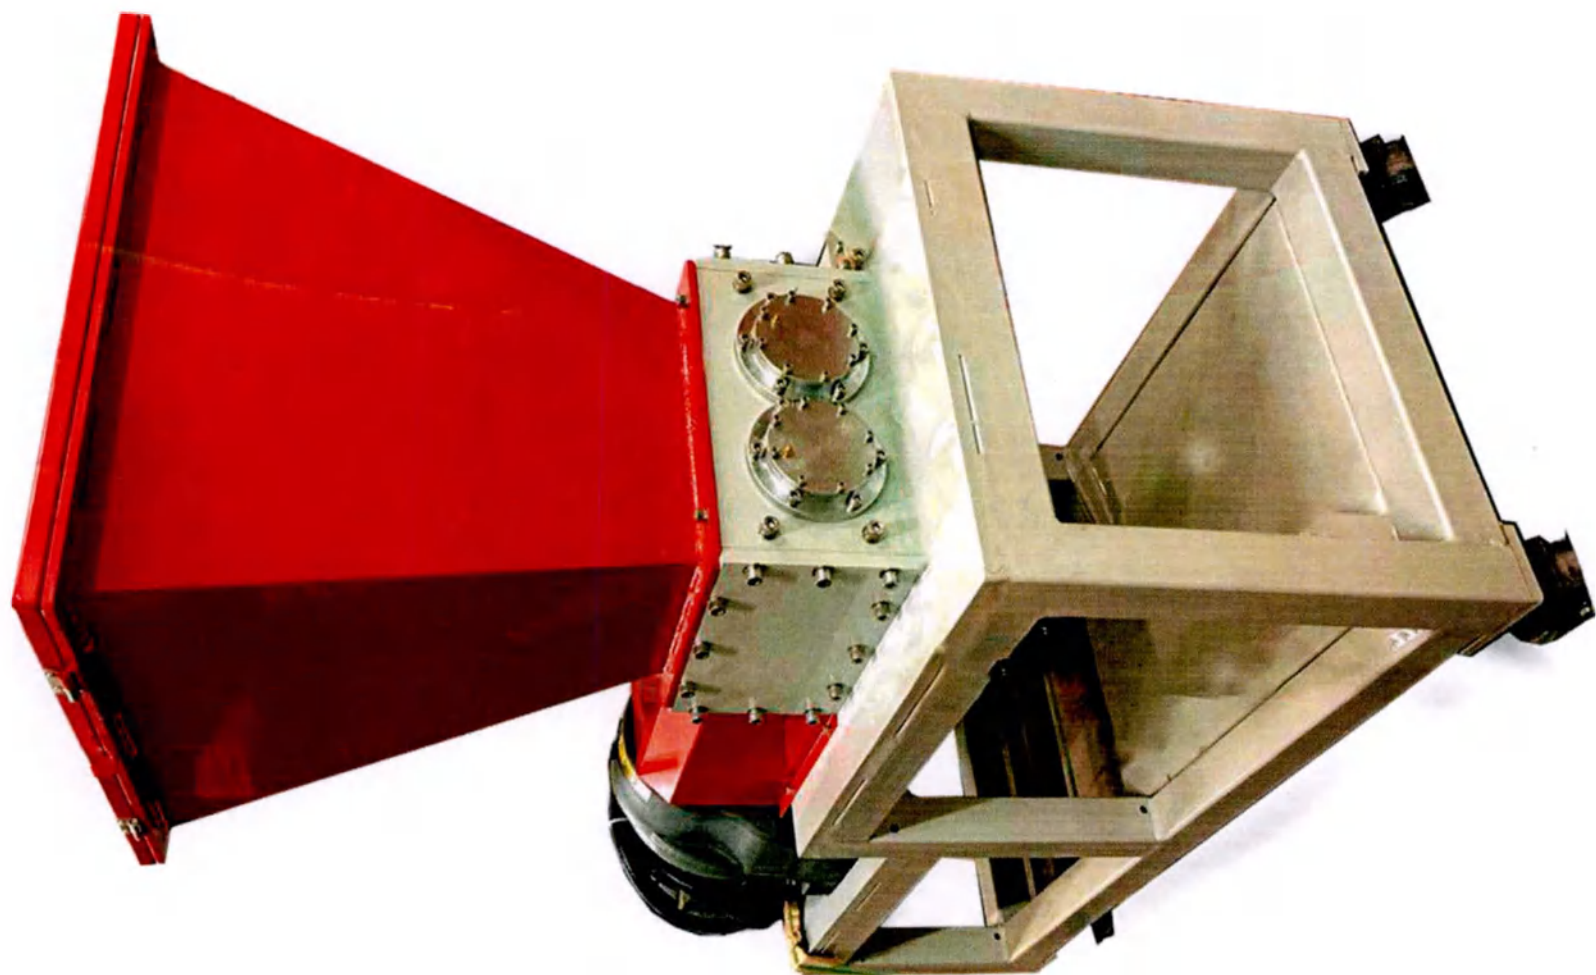

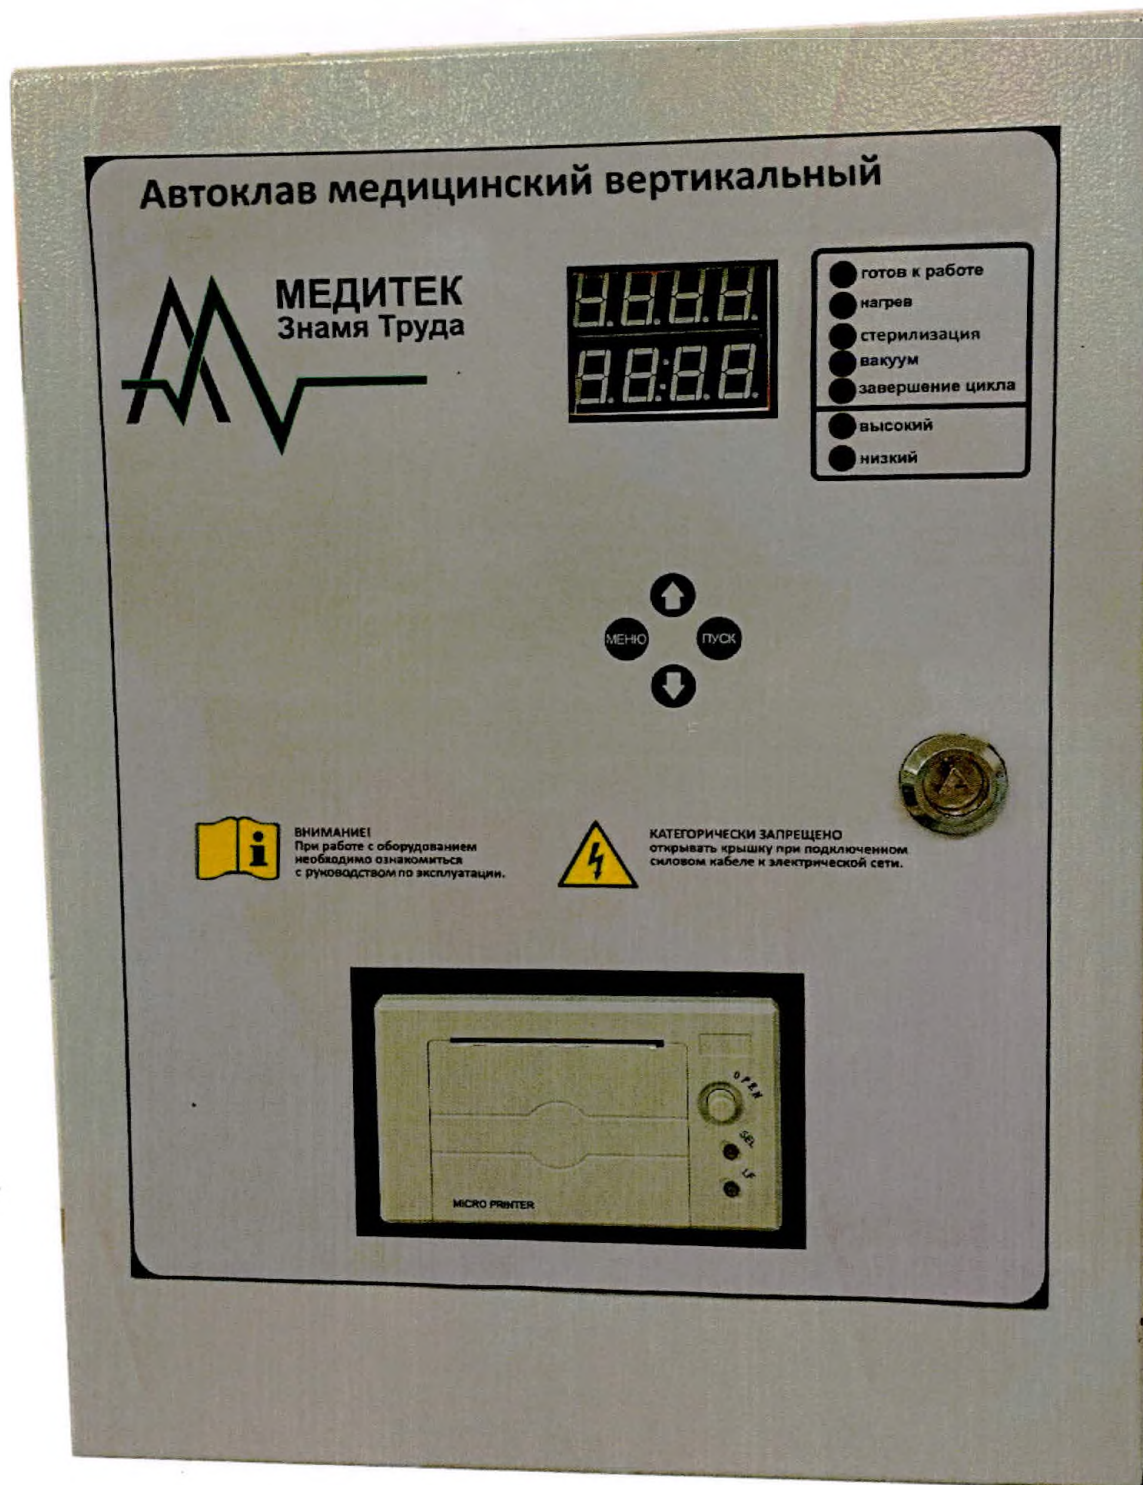

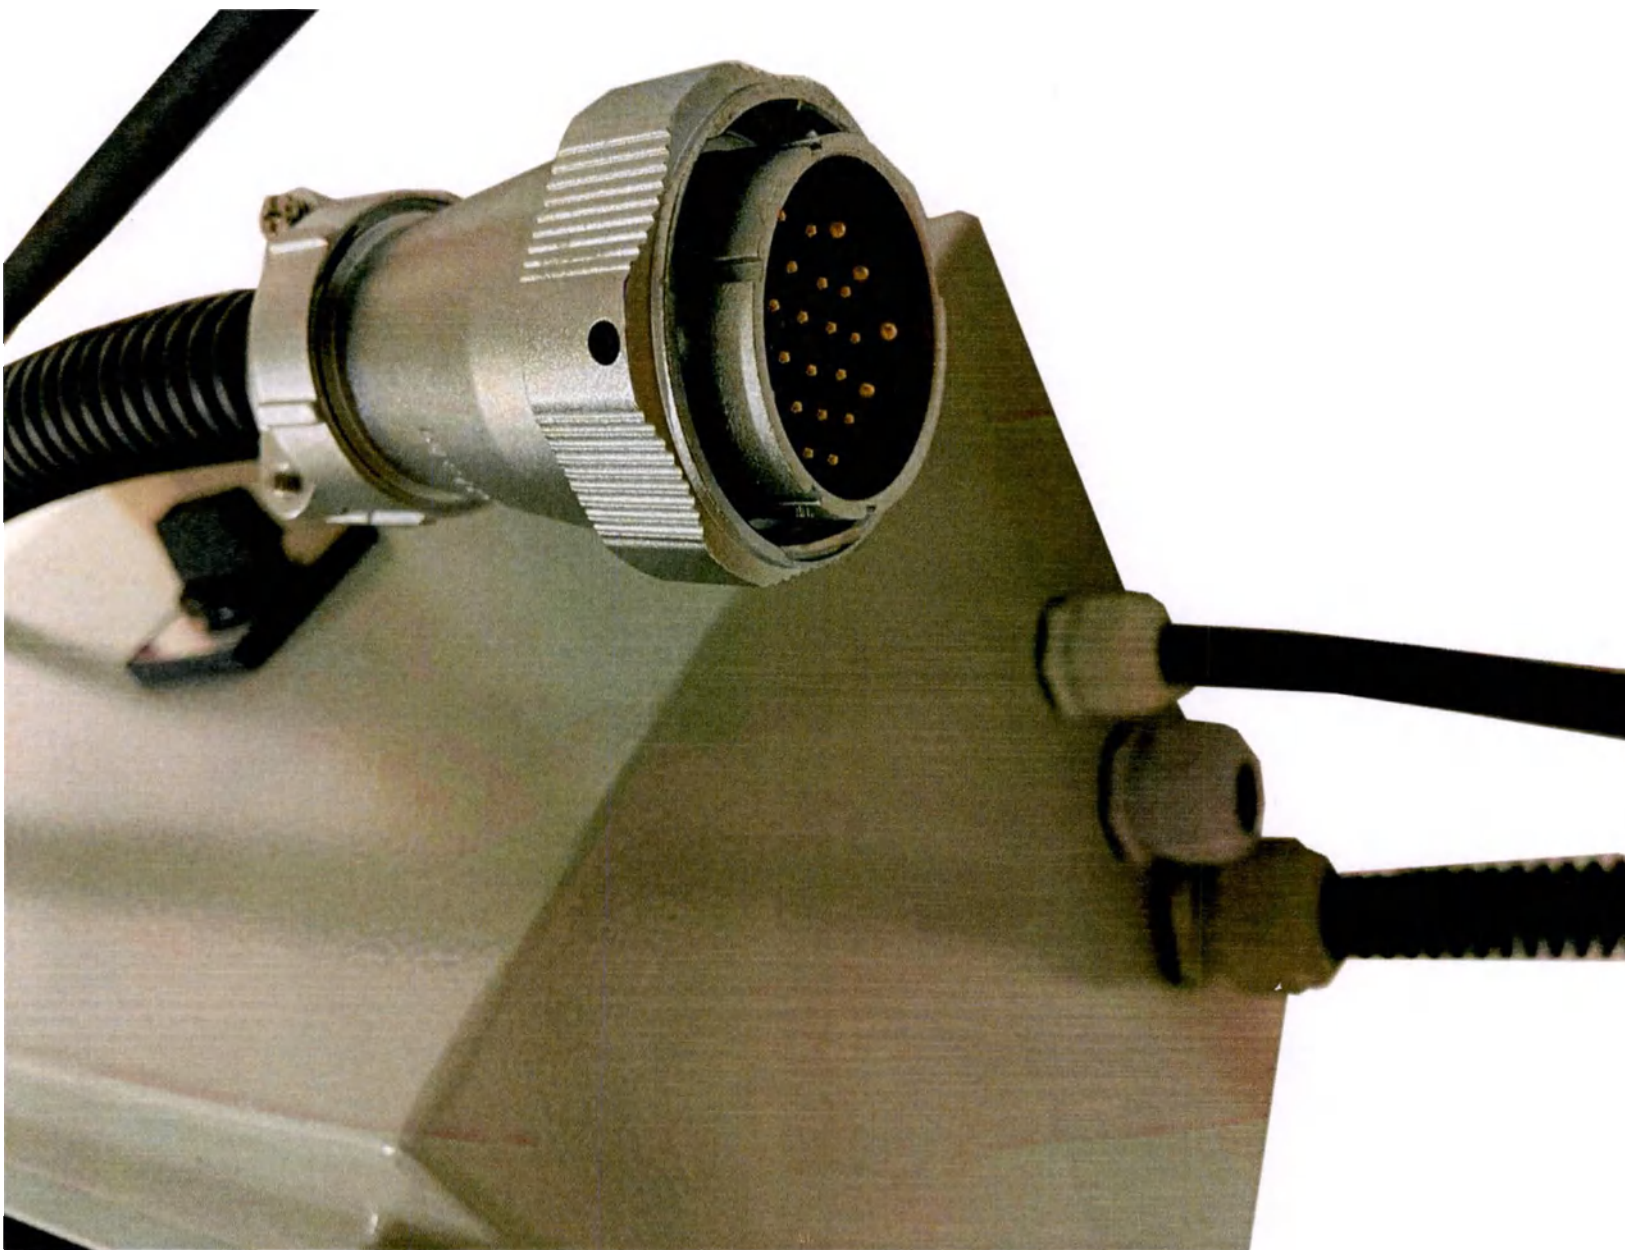


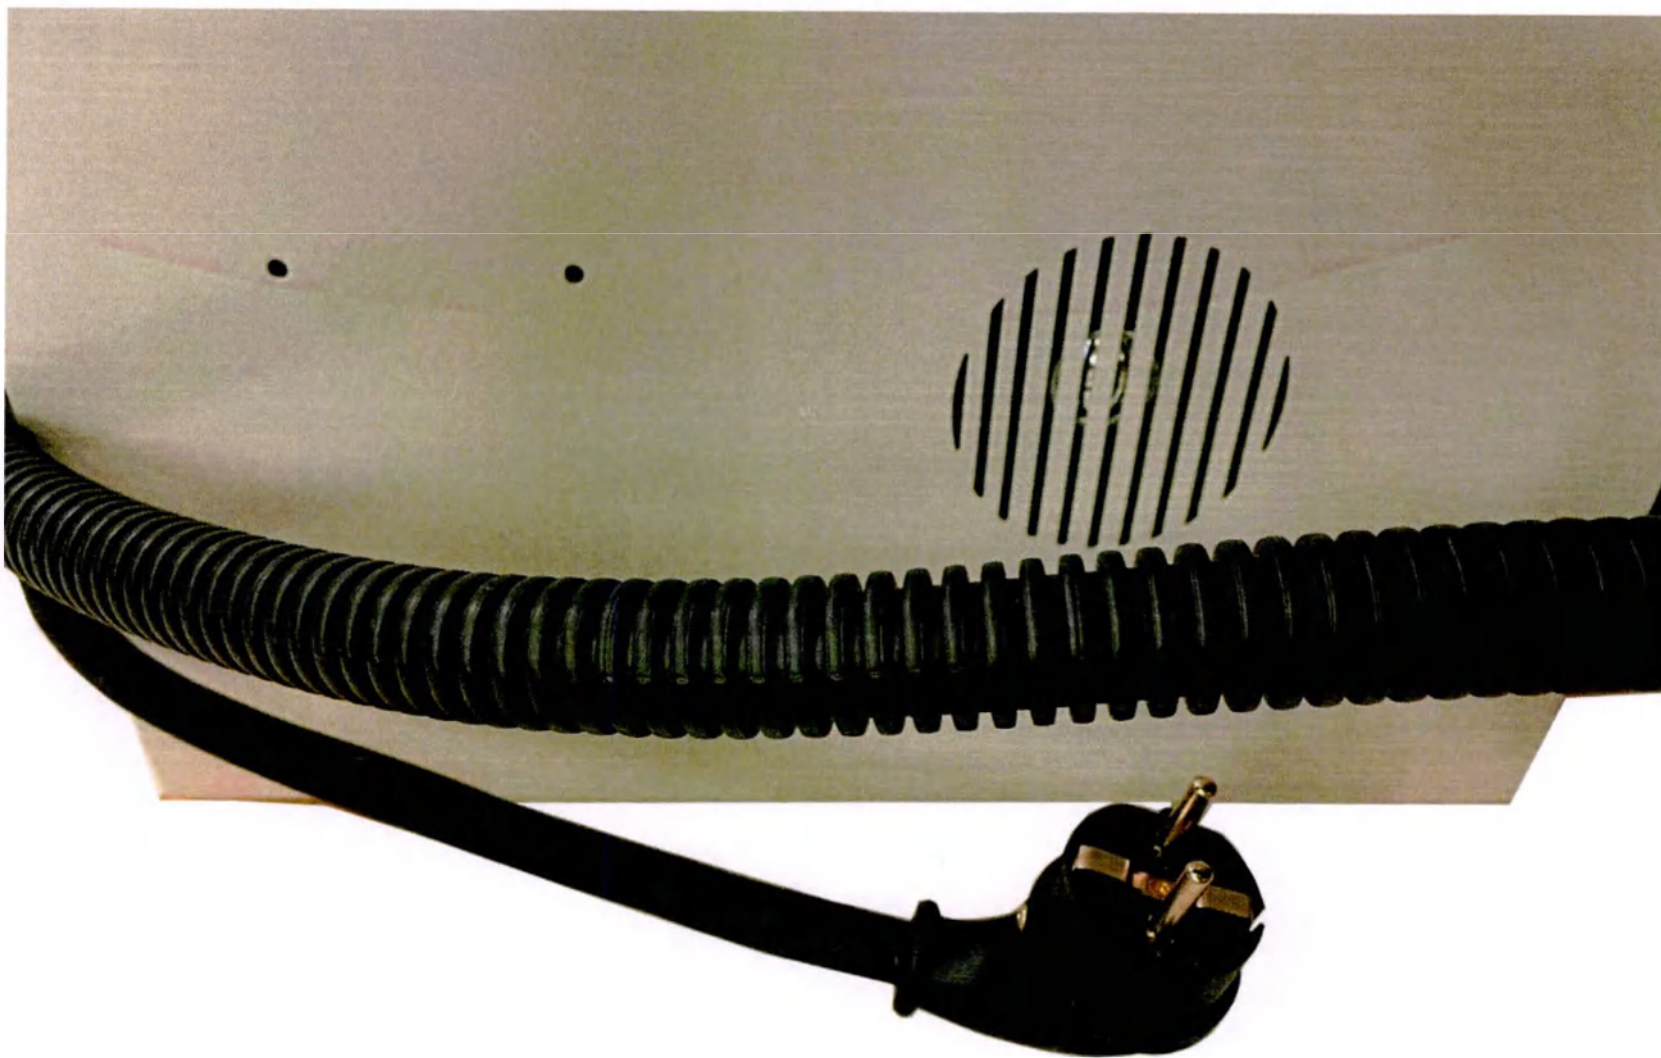

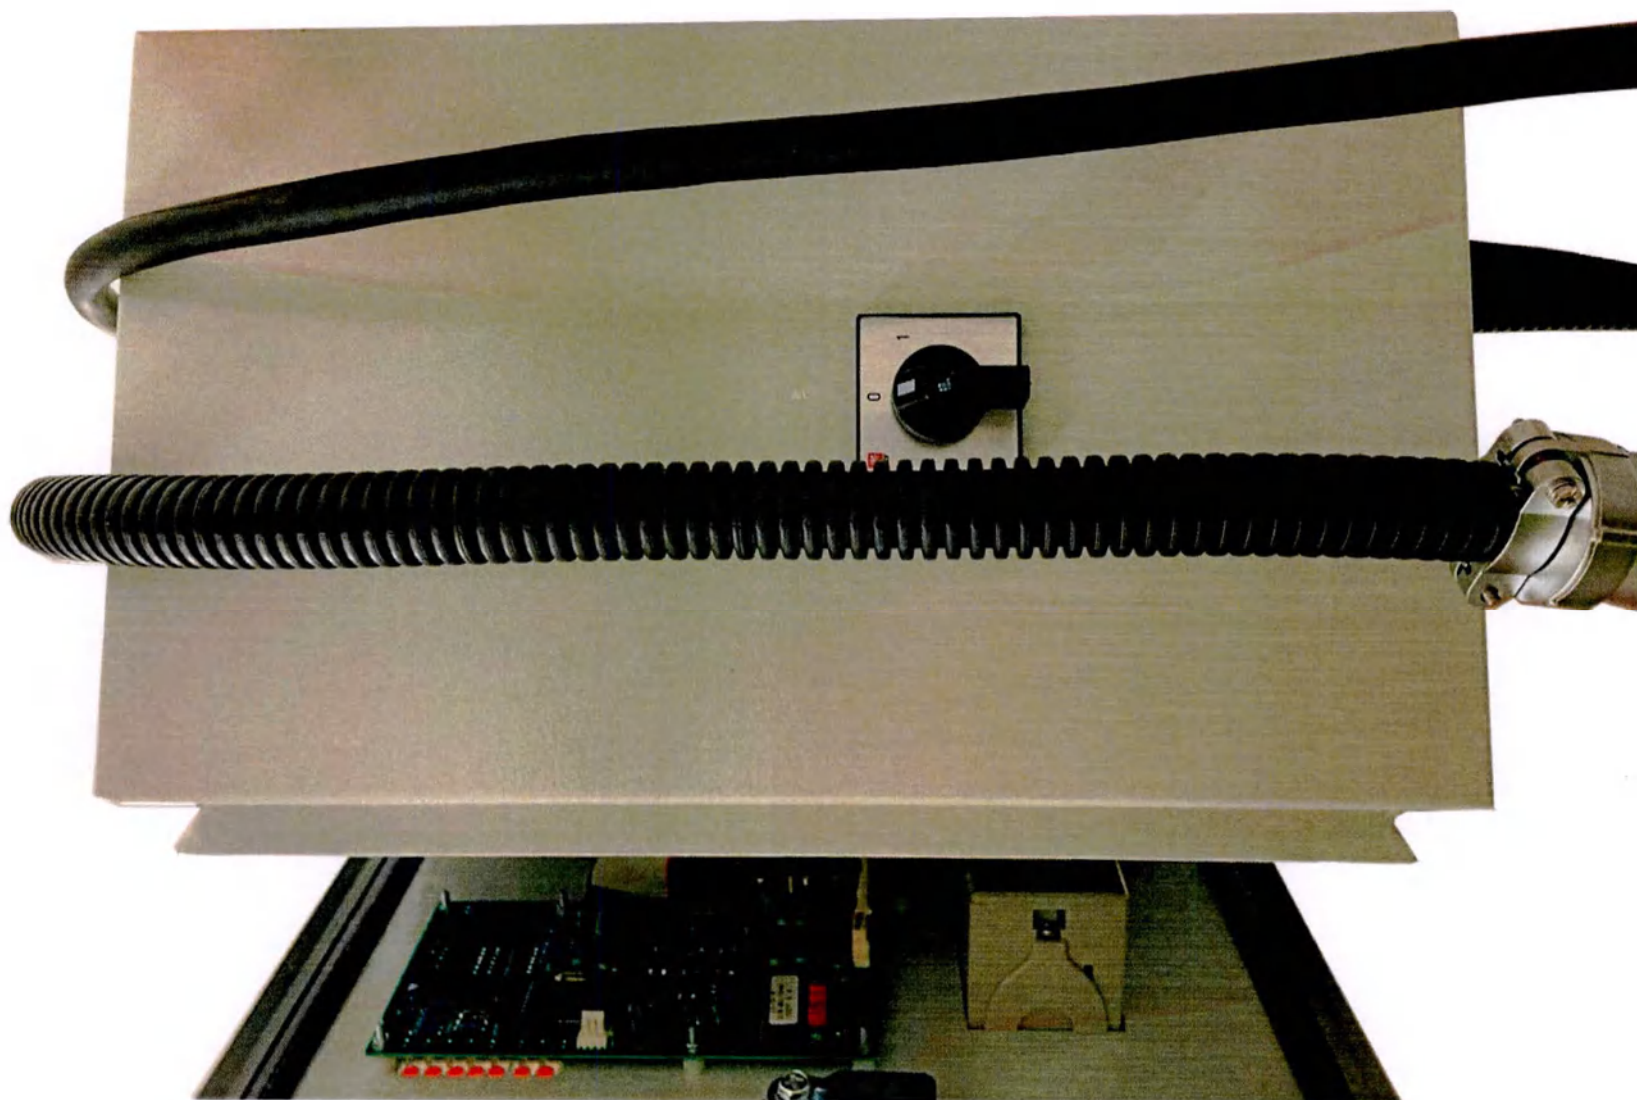




Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 М»

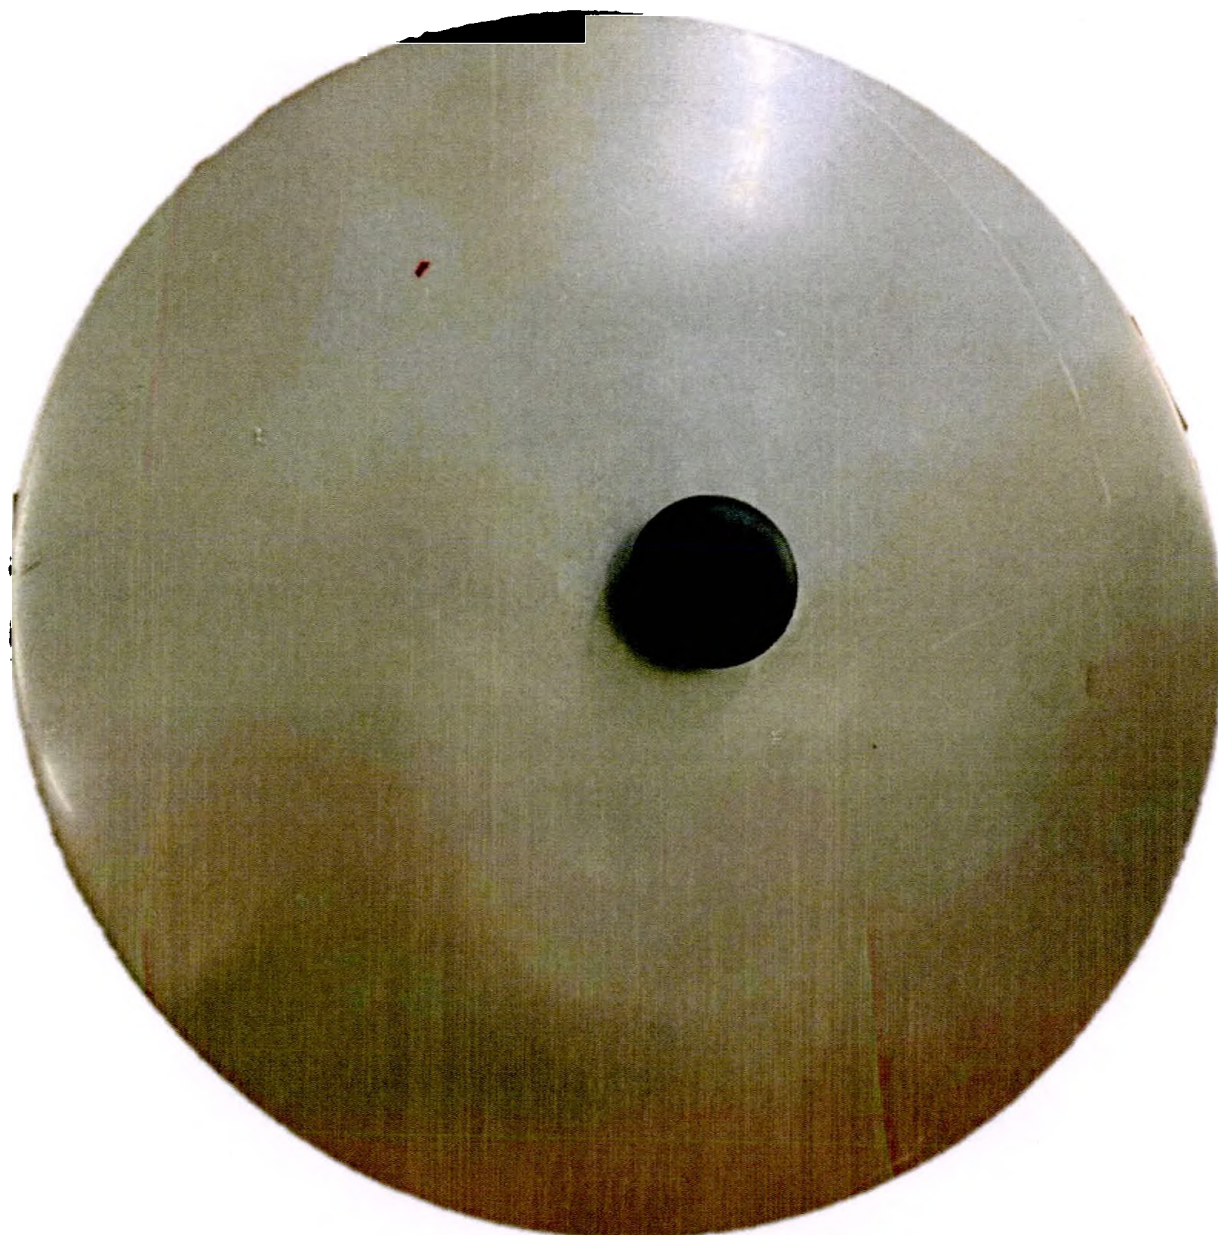

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 М»

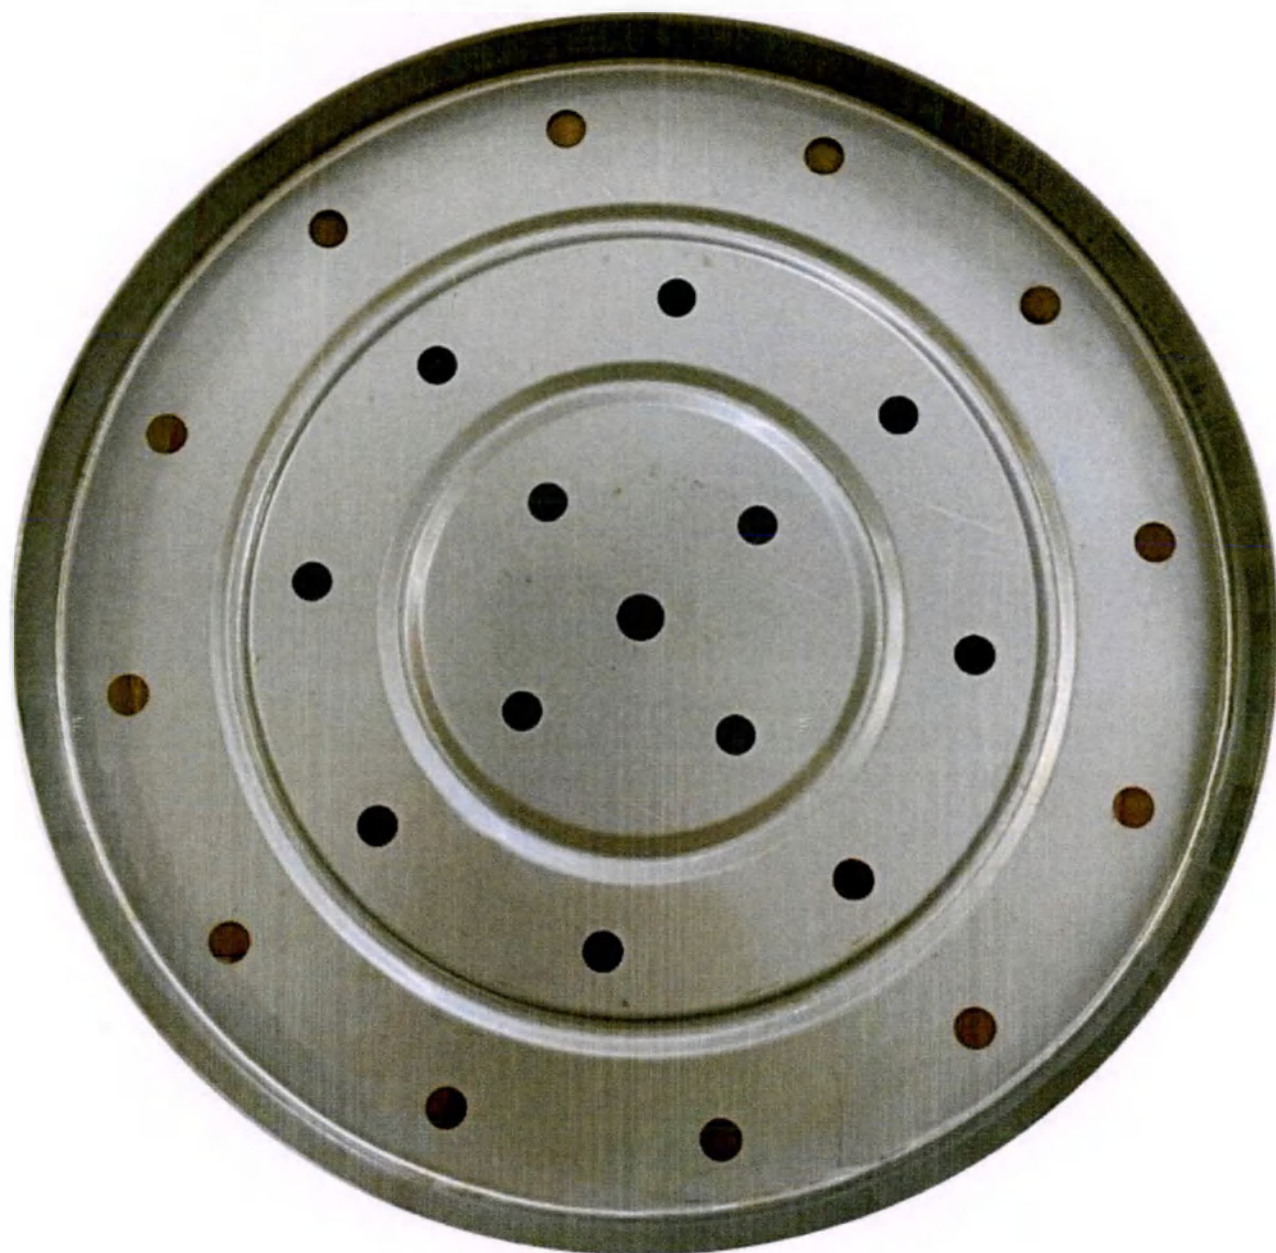

Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой





Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-100

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт
Объем стерилизационной камеры: 100 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.06.2023 г.
 SN 00110

 ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ г.

Маркировка Шредер М модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер М модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3 ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВт

 07.2023 г.
 SN 00110

 ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш100 М»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш100 М»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,

наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00110


6. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш15 Б»

Автоклав модуль 1-15




Камера автоклава модуль 1-15

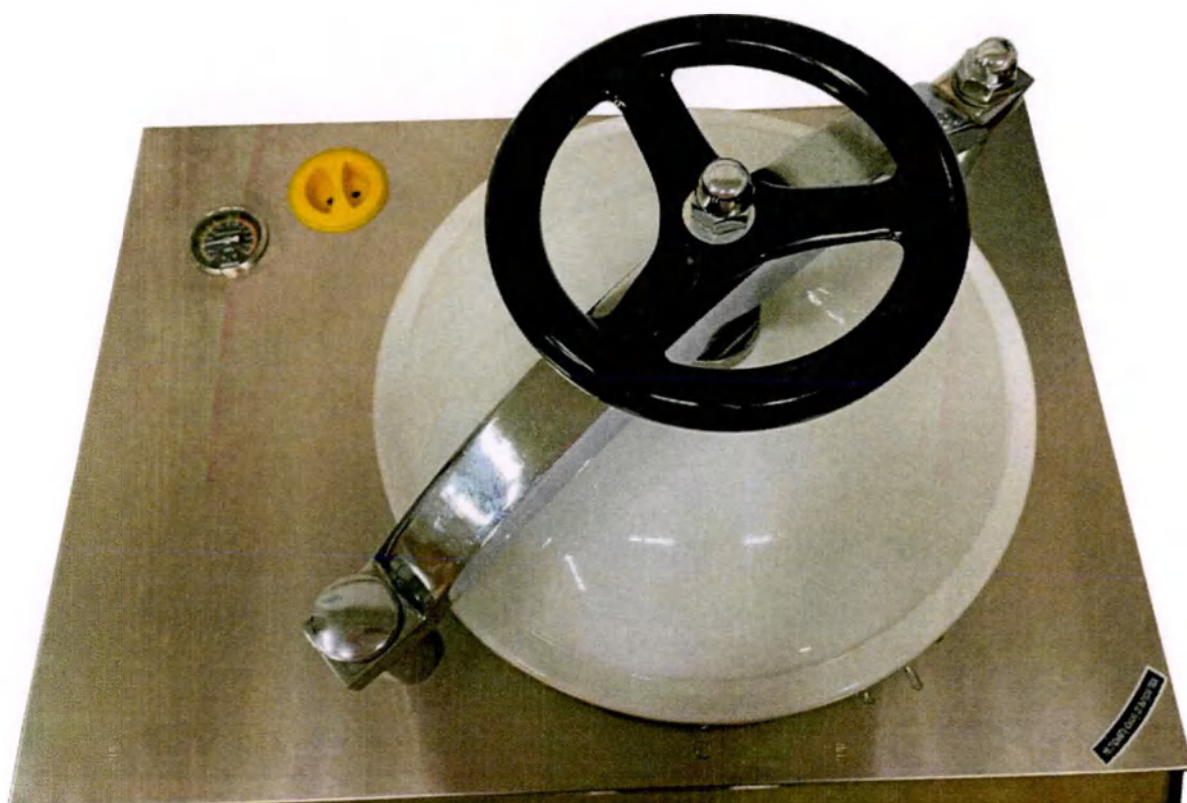


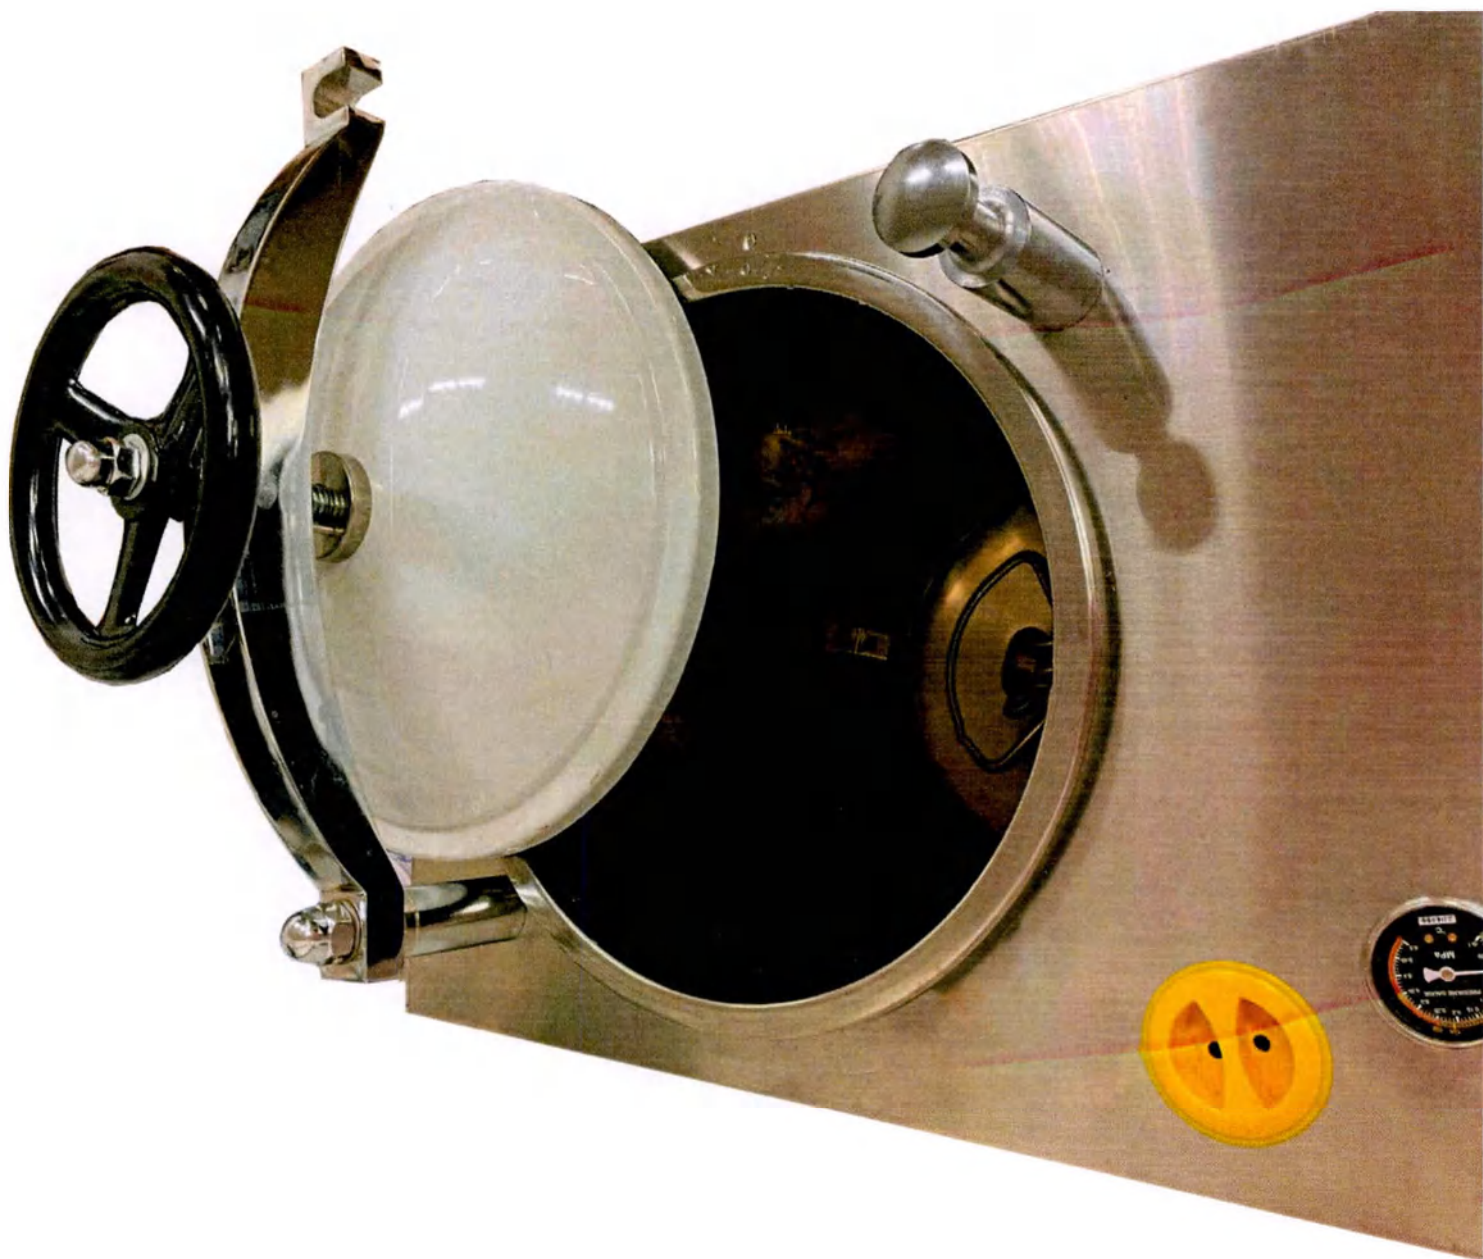



Шредер Б модуль 2




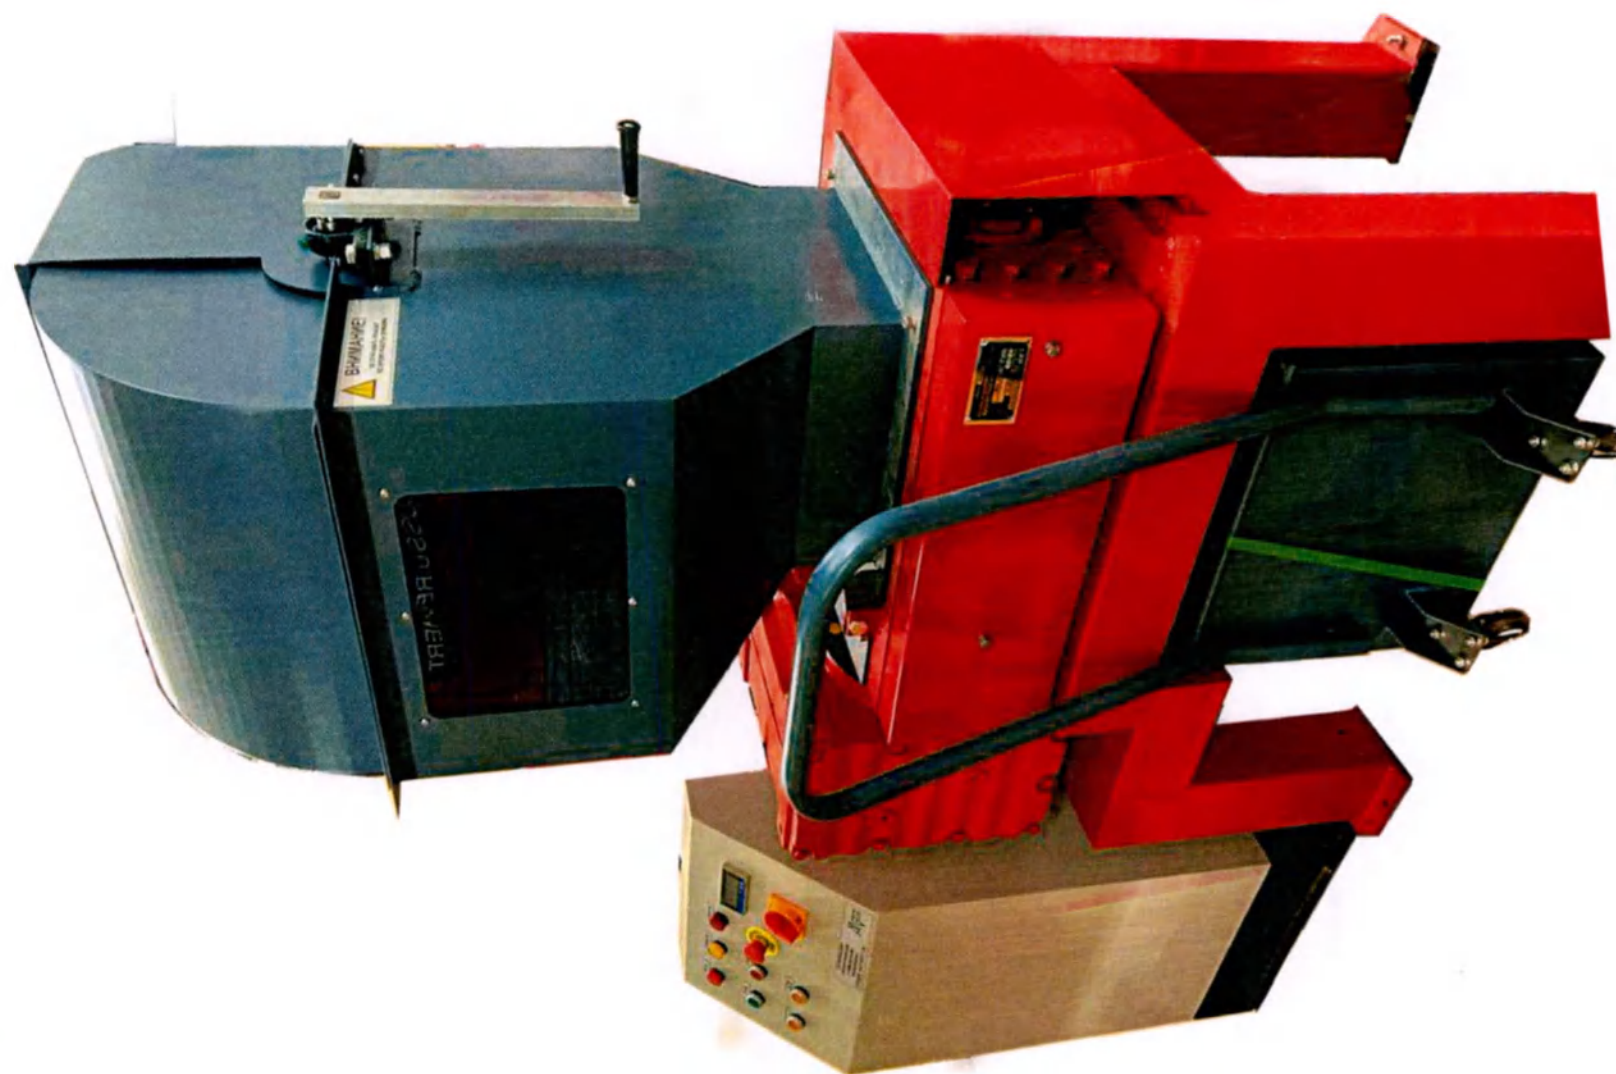

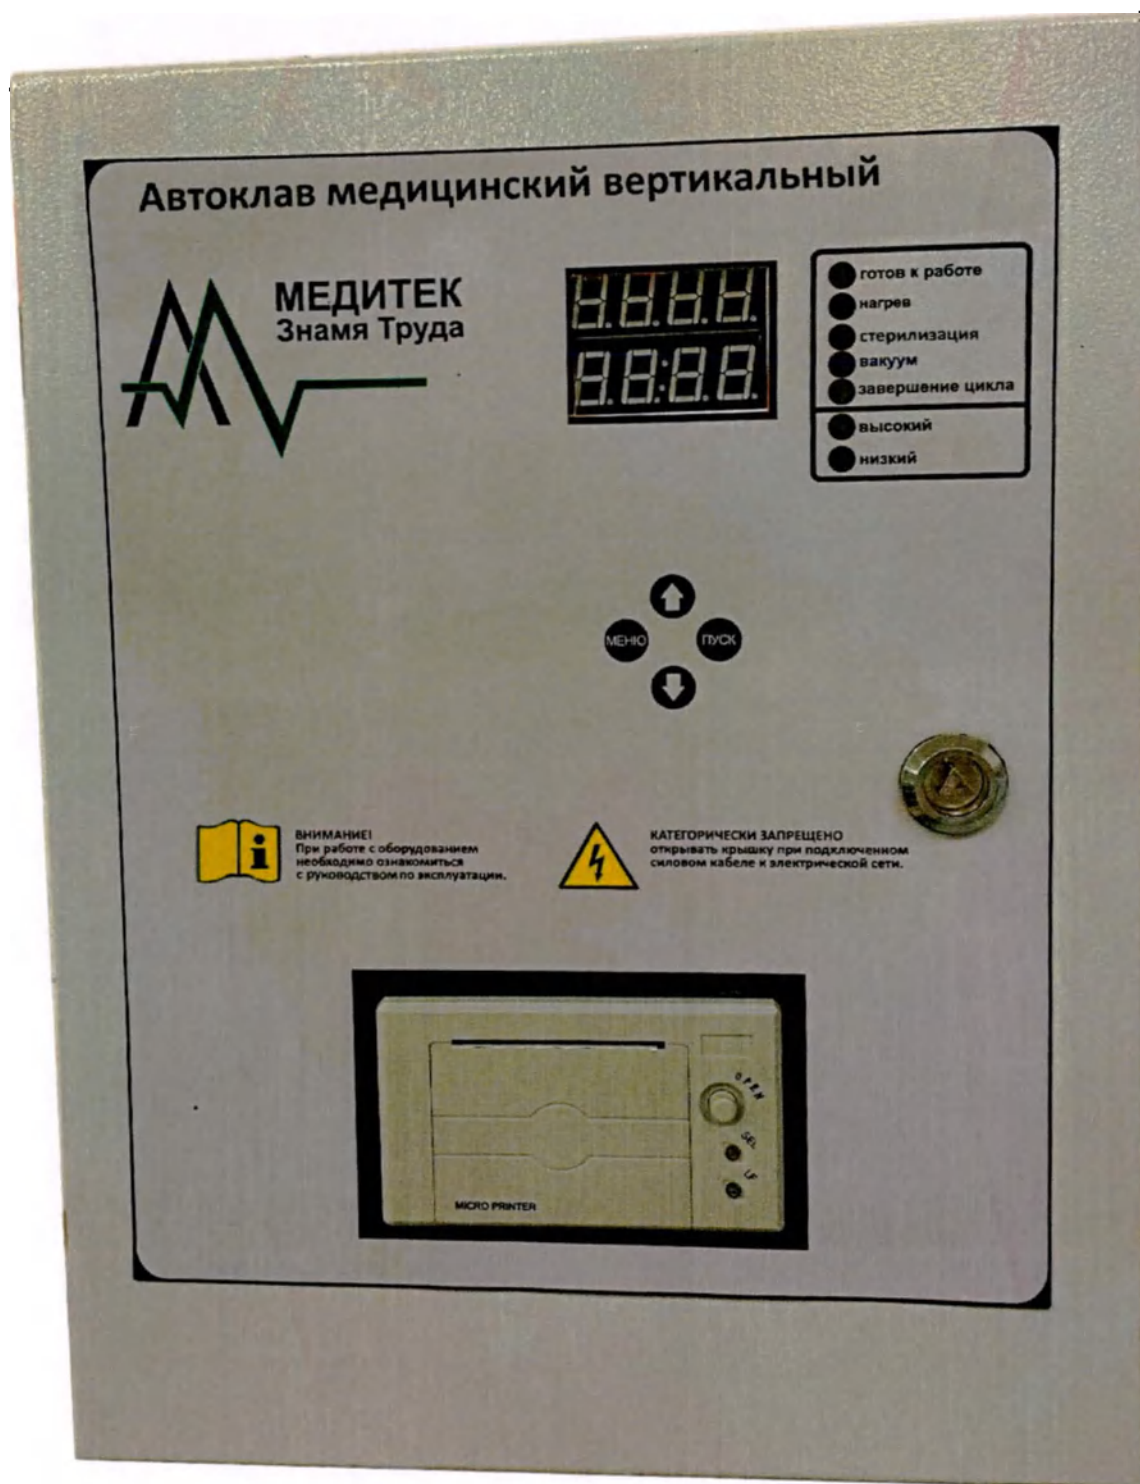


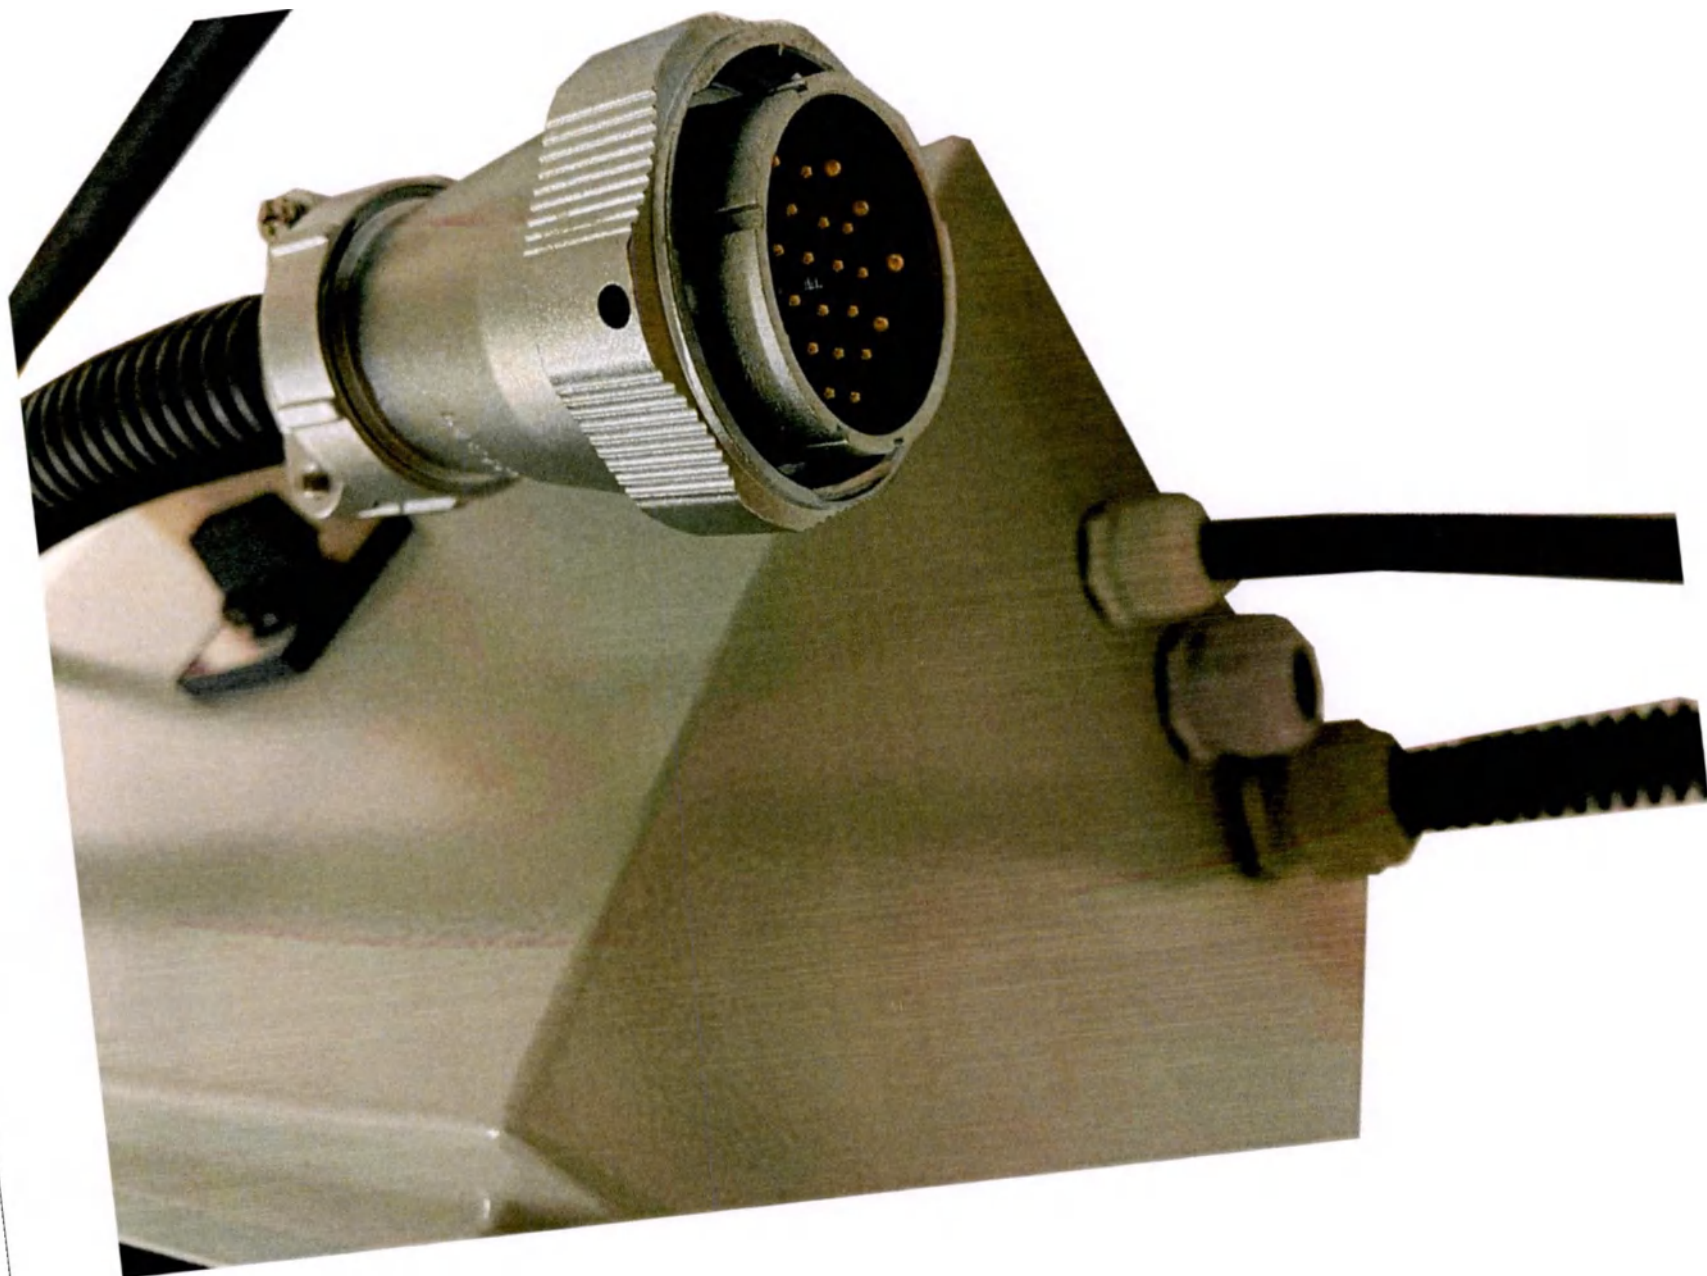

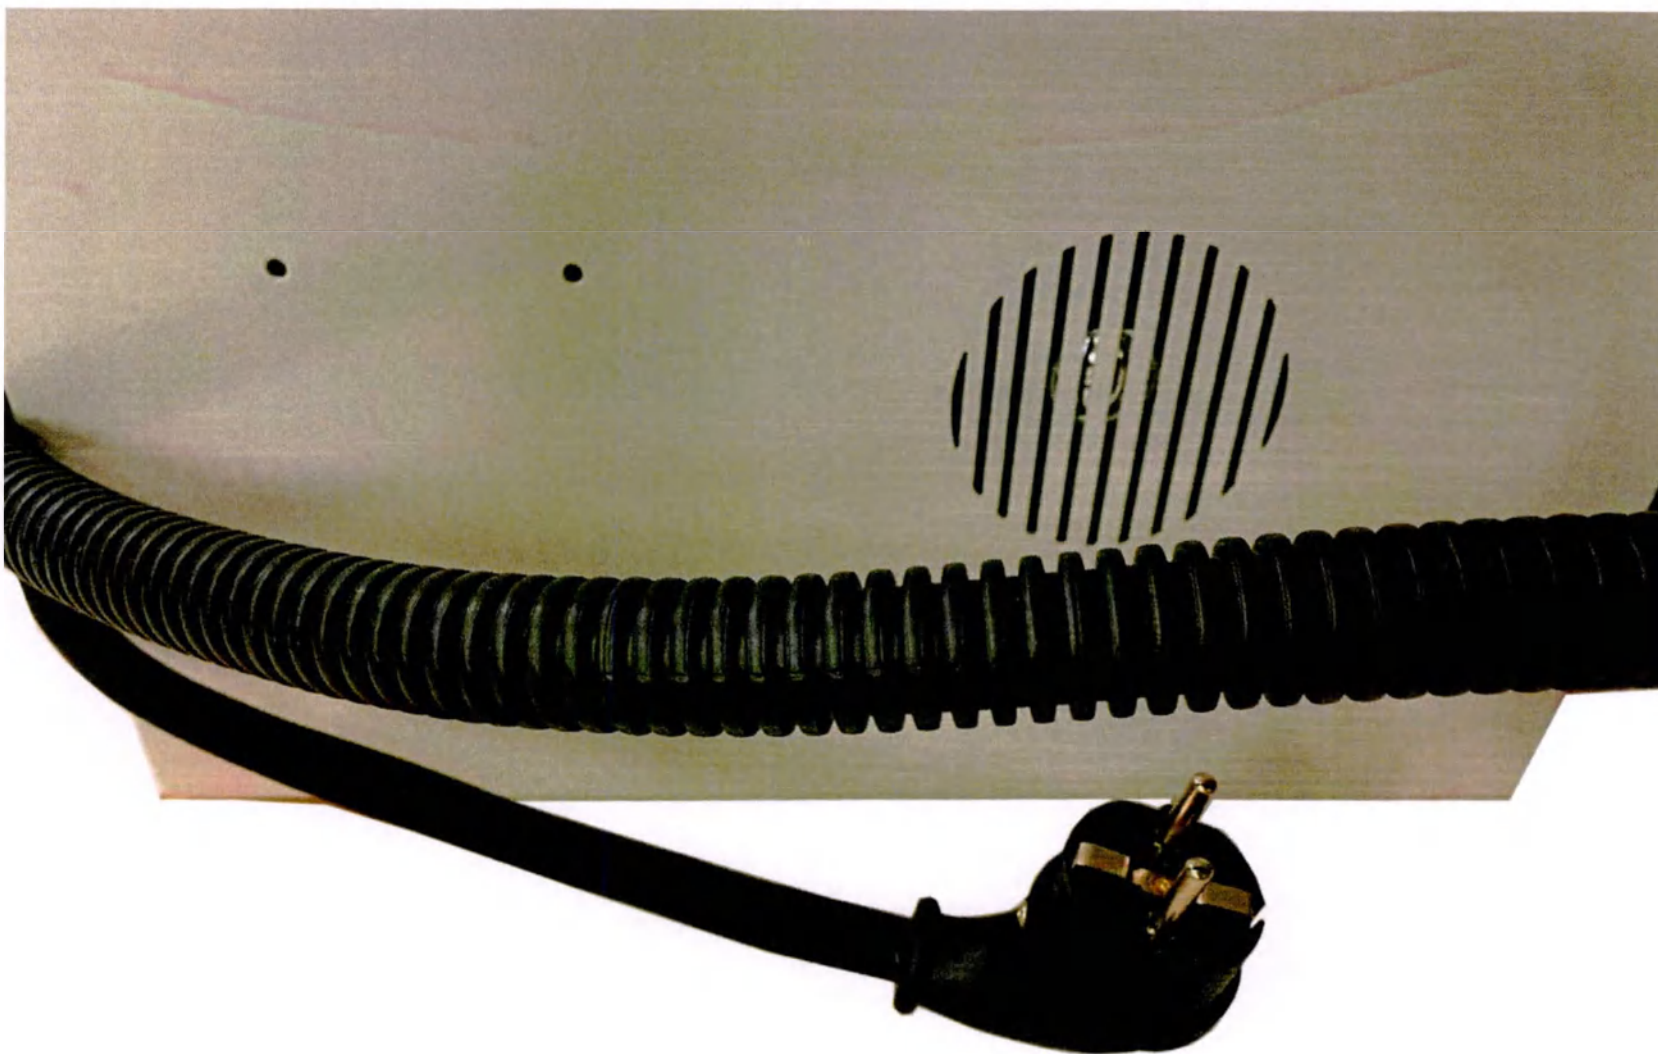

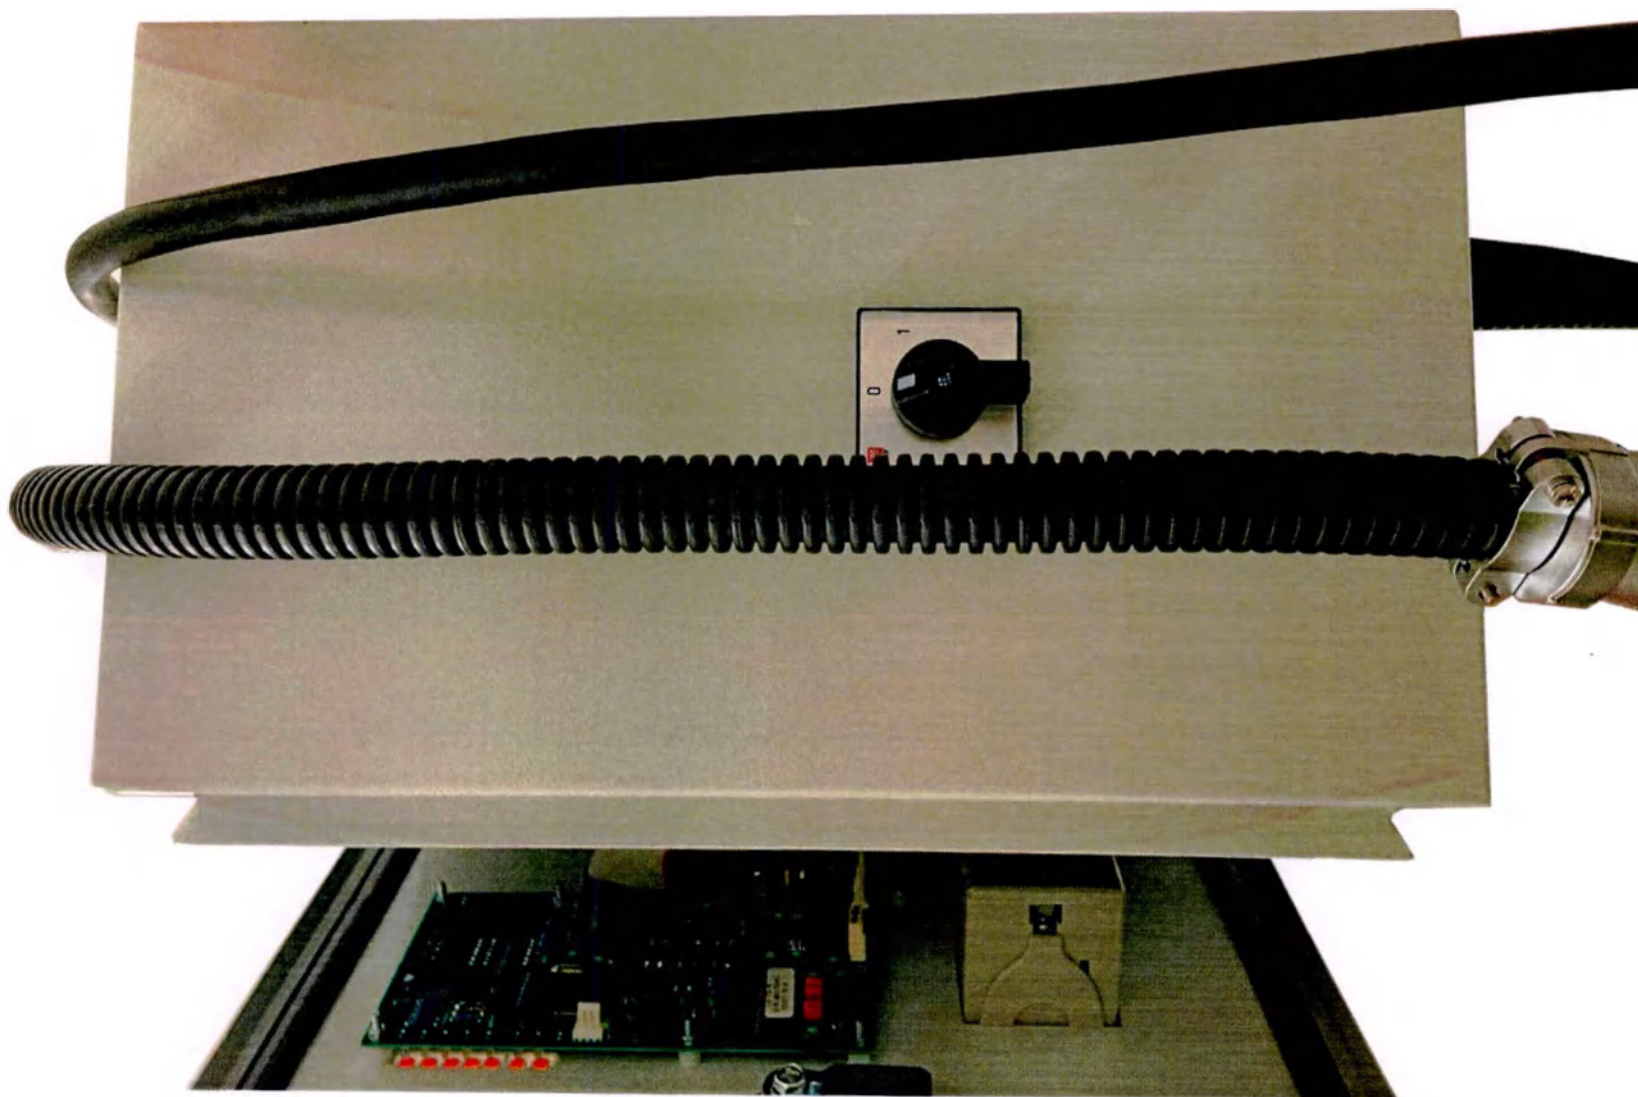


Блок управления модуль 4

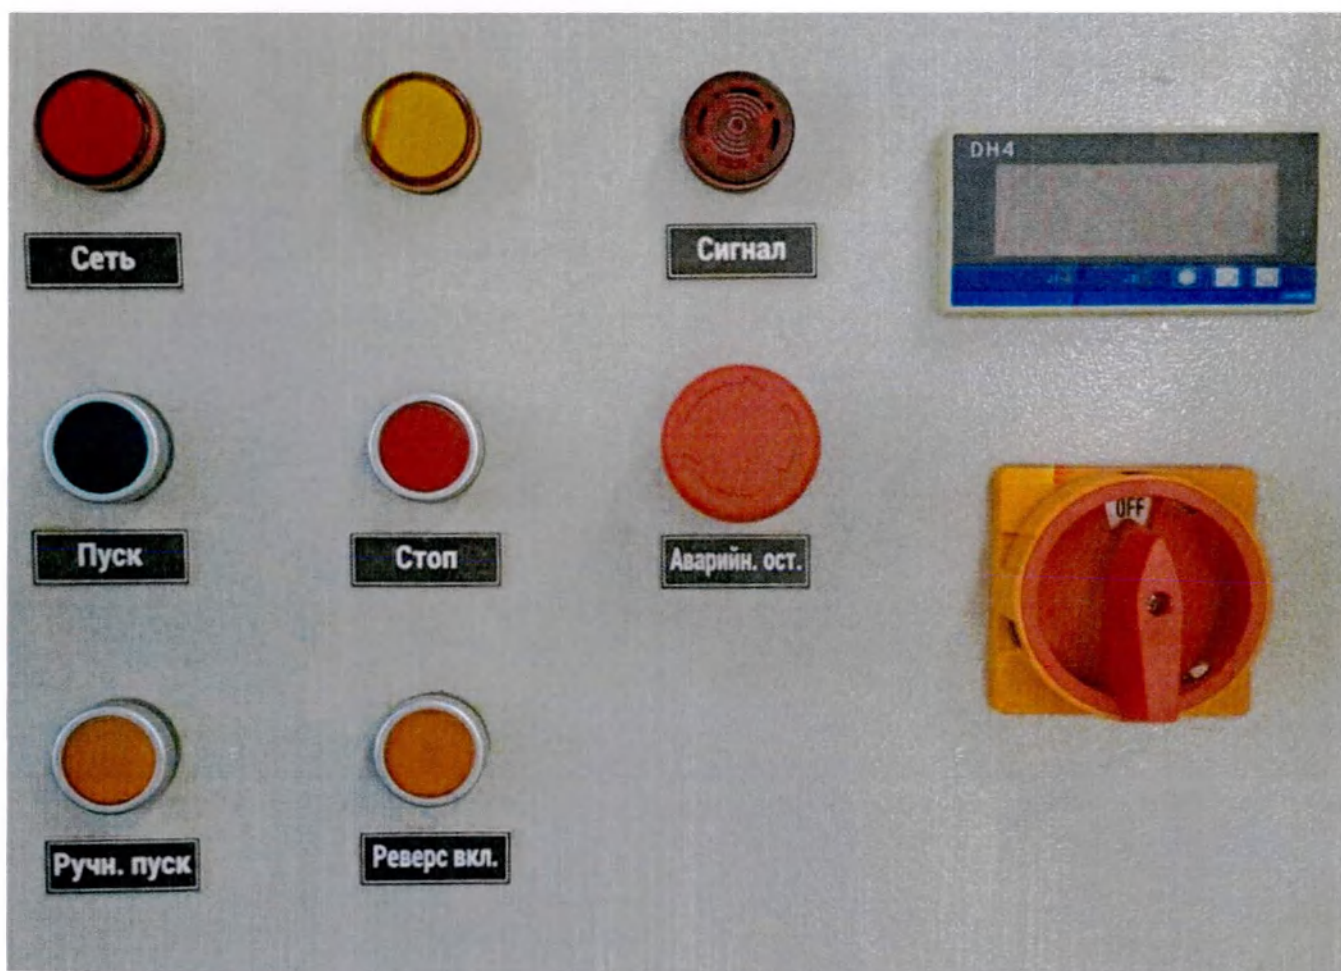


Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР®-Ш15 Б»



Крышка металлическая « «БАЛТНЕР®-Ш15 Б»

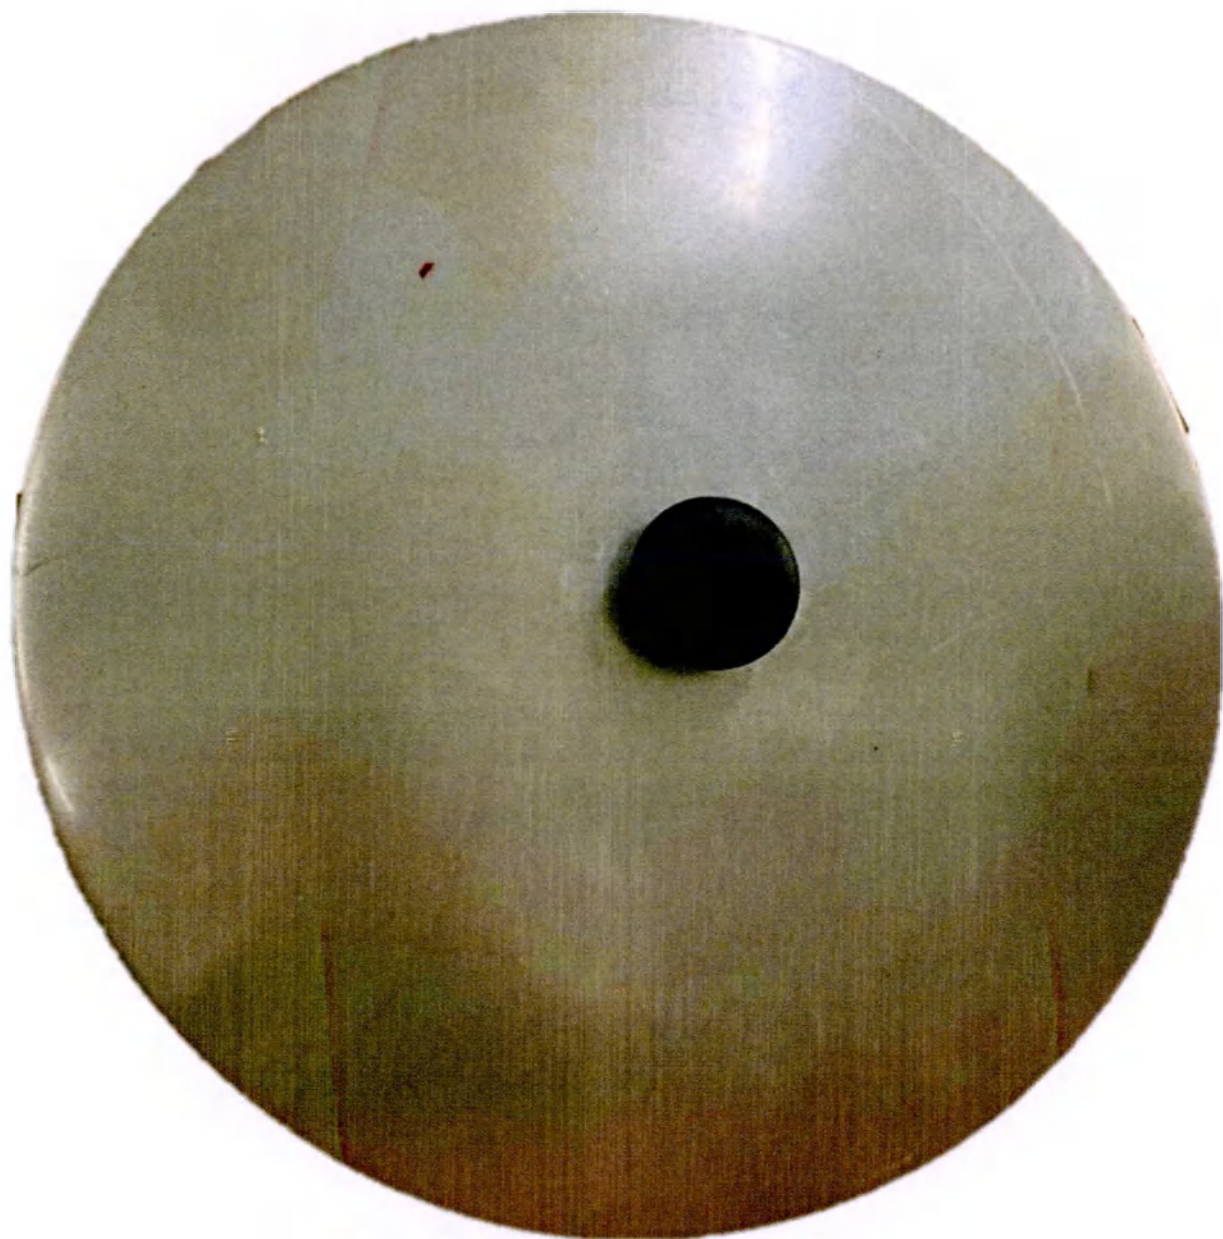

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР®-Ш15 Б»

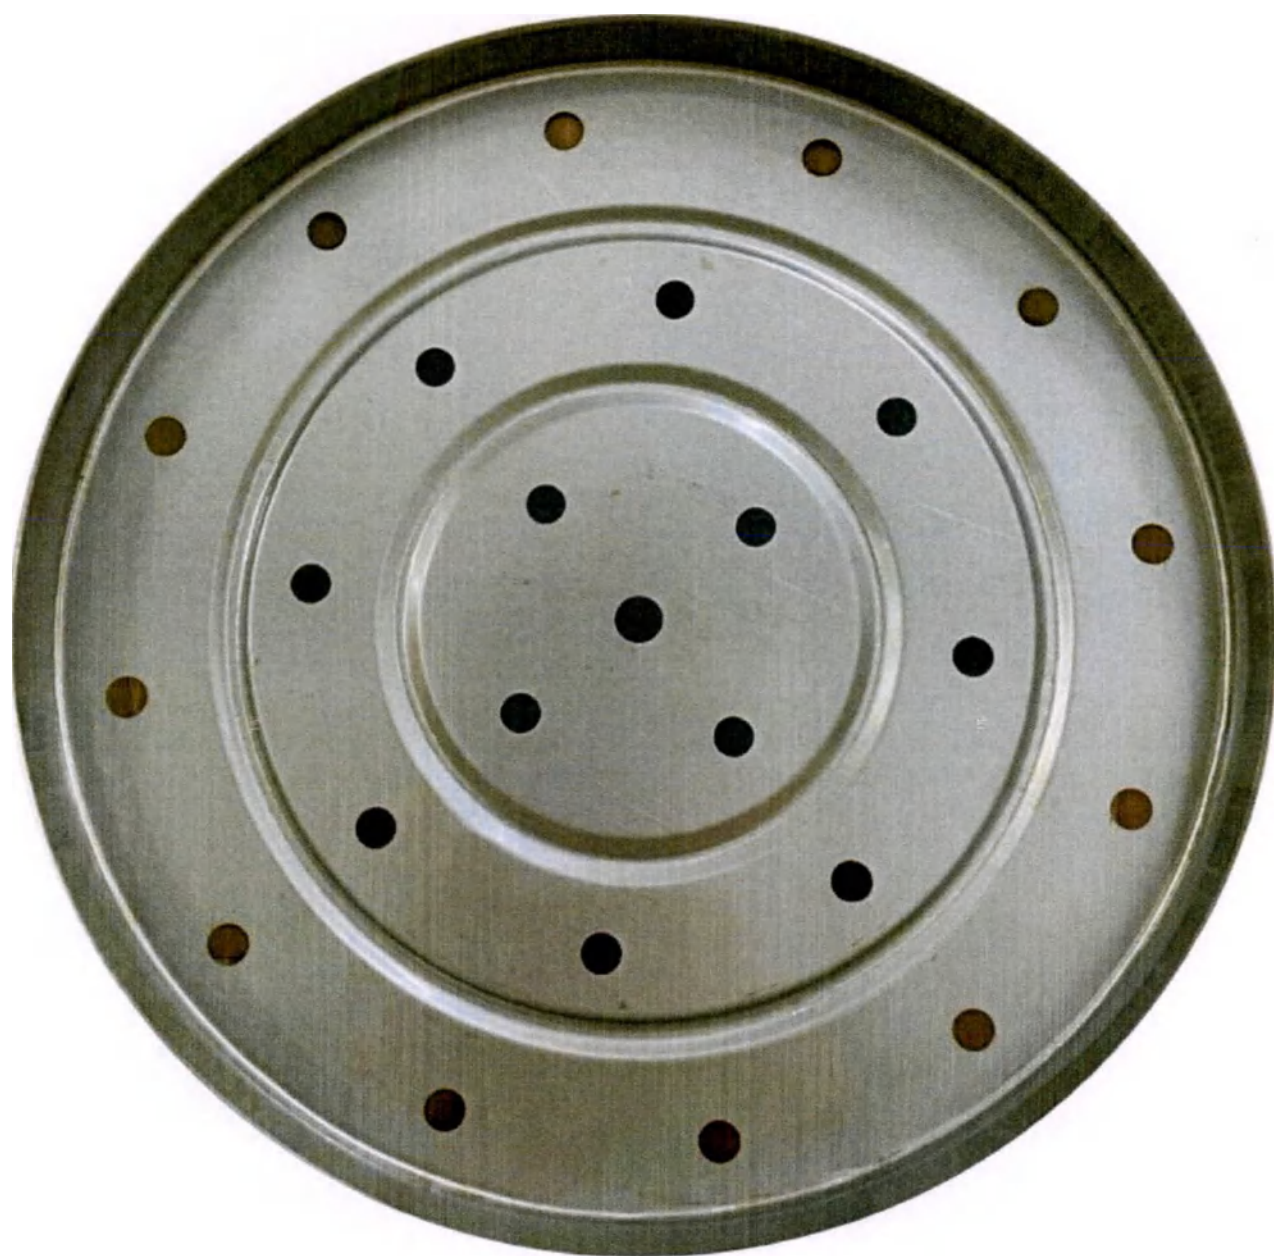


Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



Трубка полимерная металлическая

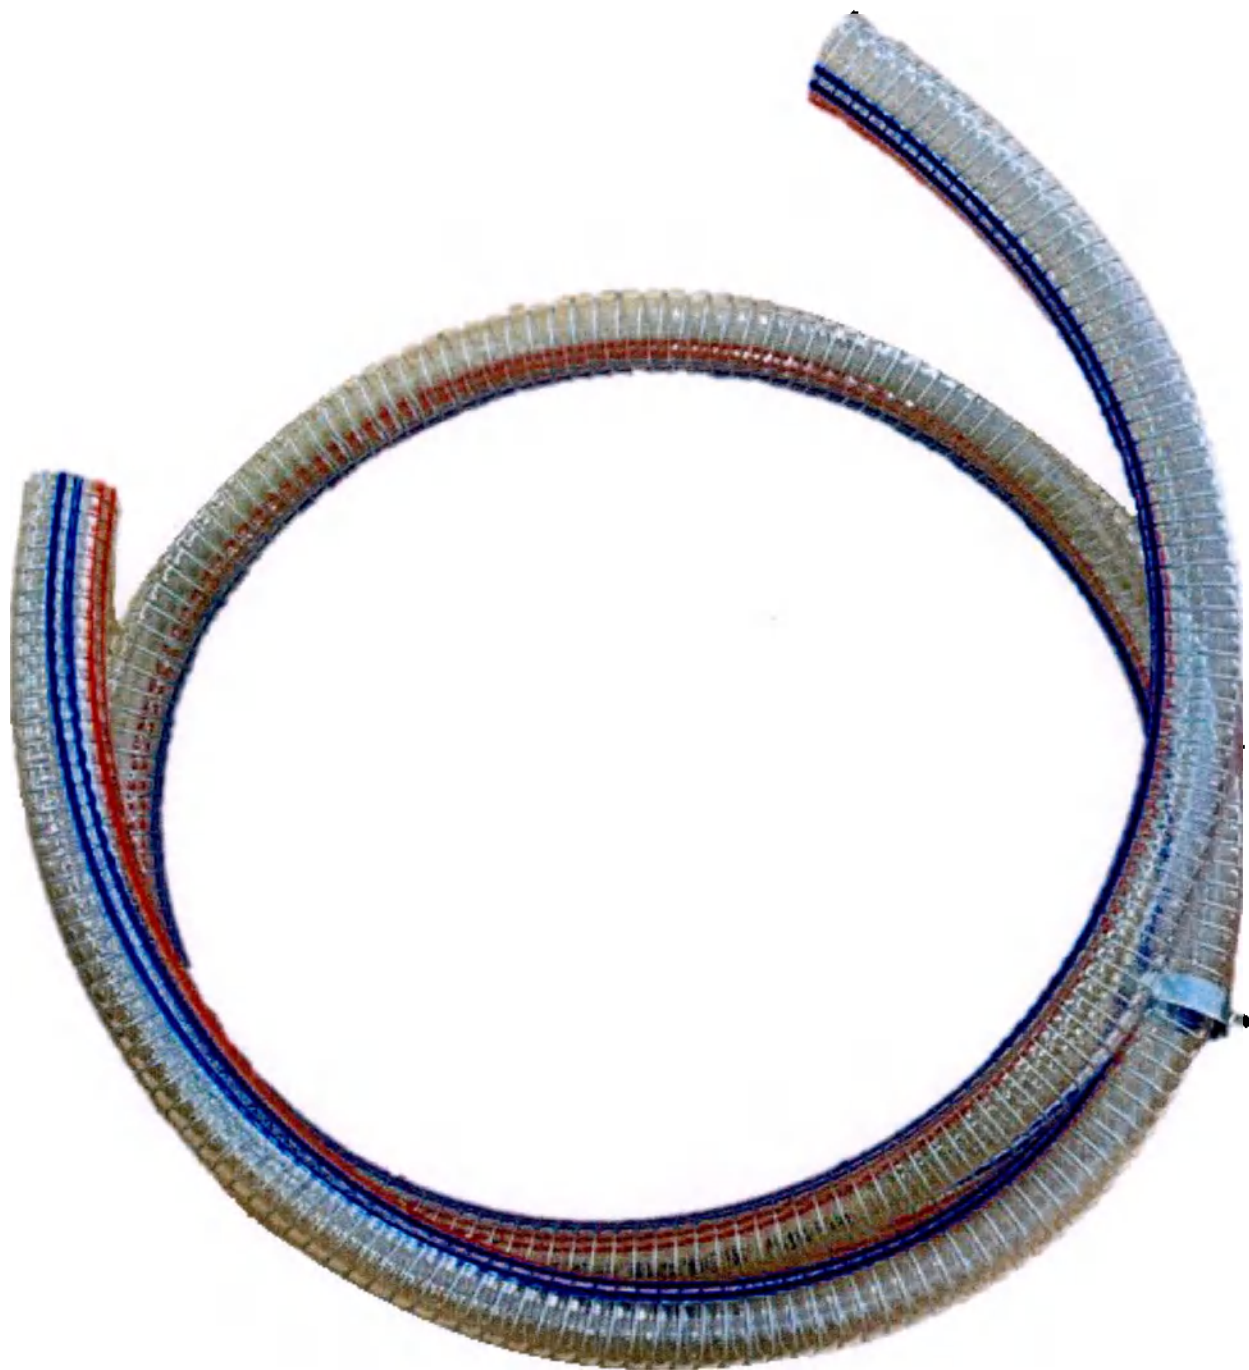

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-15

**МЕДИТЕК**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-15

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 2,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 15 л
Максимальная рабочая температура: 126°C
Максимальное рабочее давление: 0,15 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

 07.2023 г.
 SN 00115

Маркировка Шредер Б модуль 2

**МЕДИТЕК**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

 07.2023 г.
 SN 00115

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш15 Б»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш15 Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00115


7. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш30 Б»

Автоклав модуль 1-30




Камера автоклава модуль 1-30

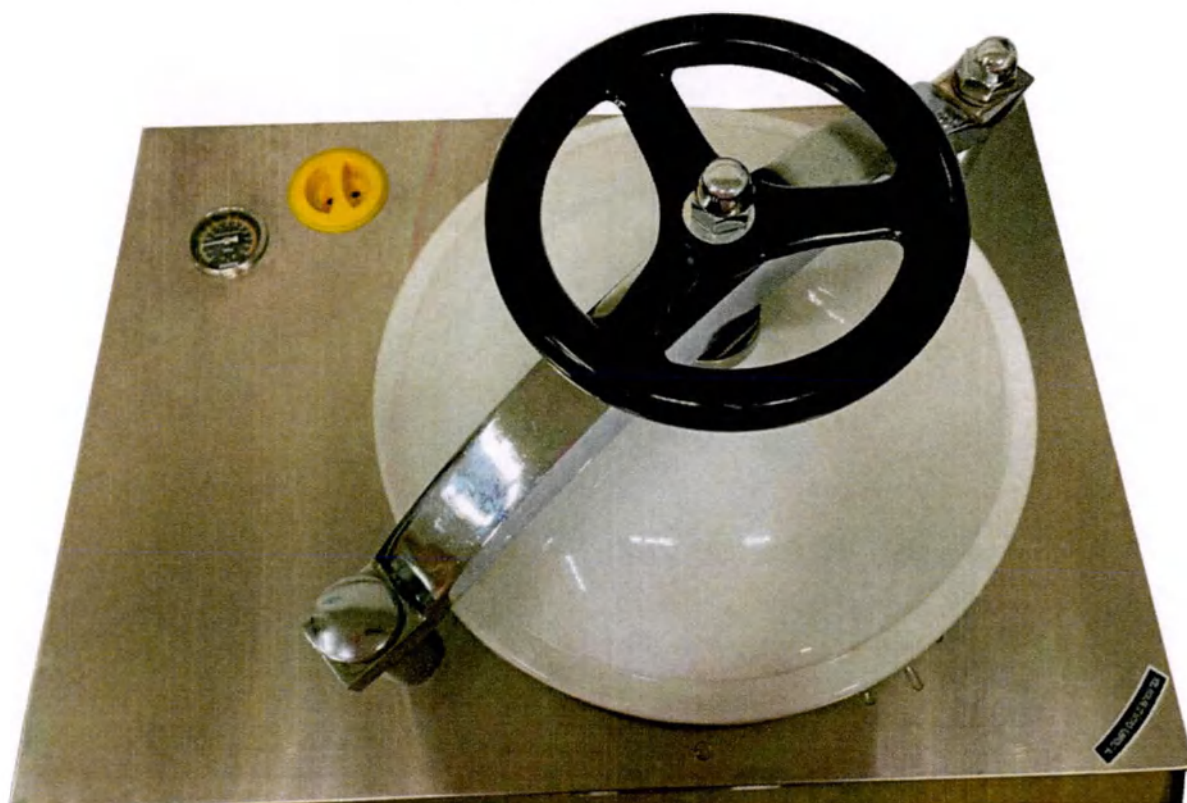


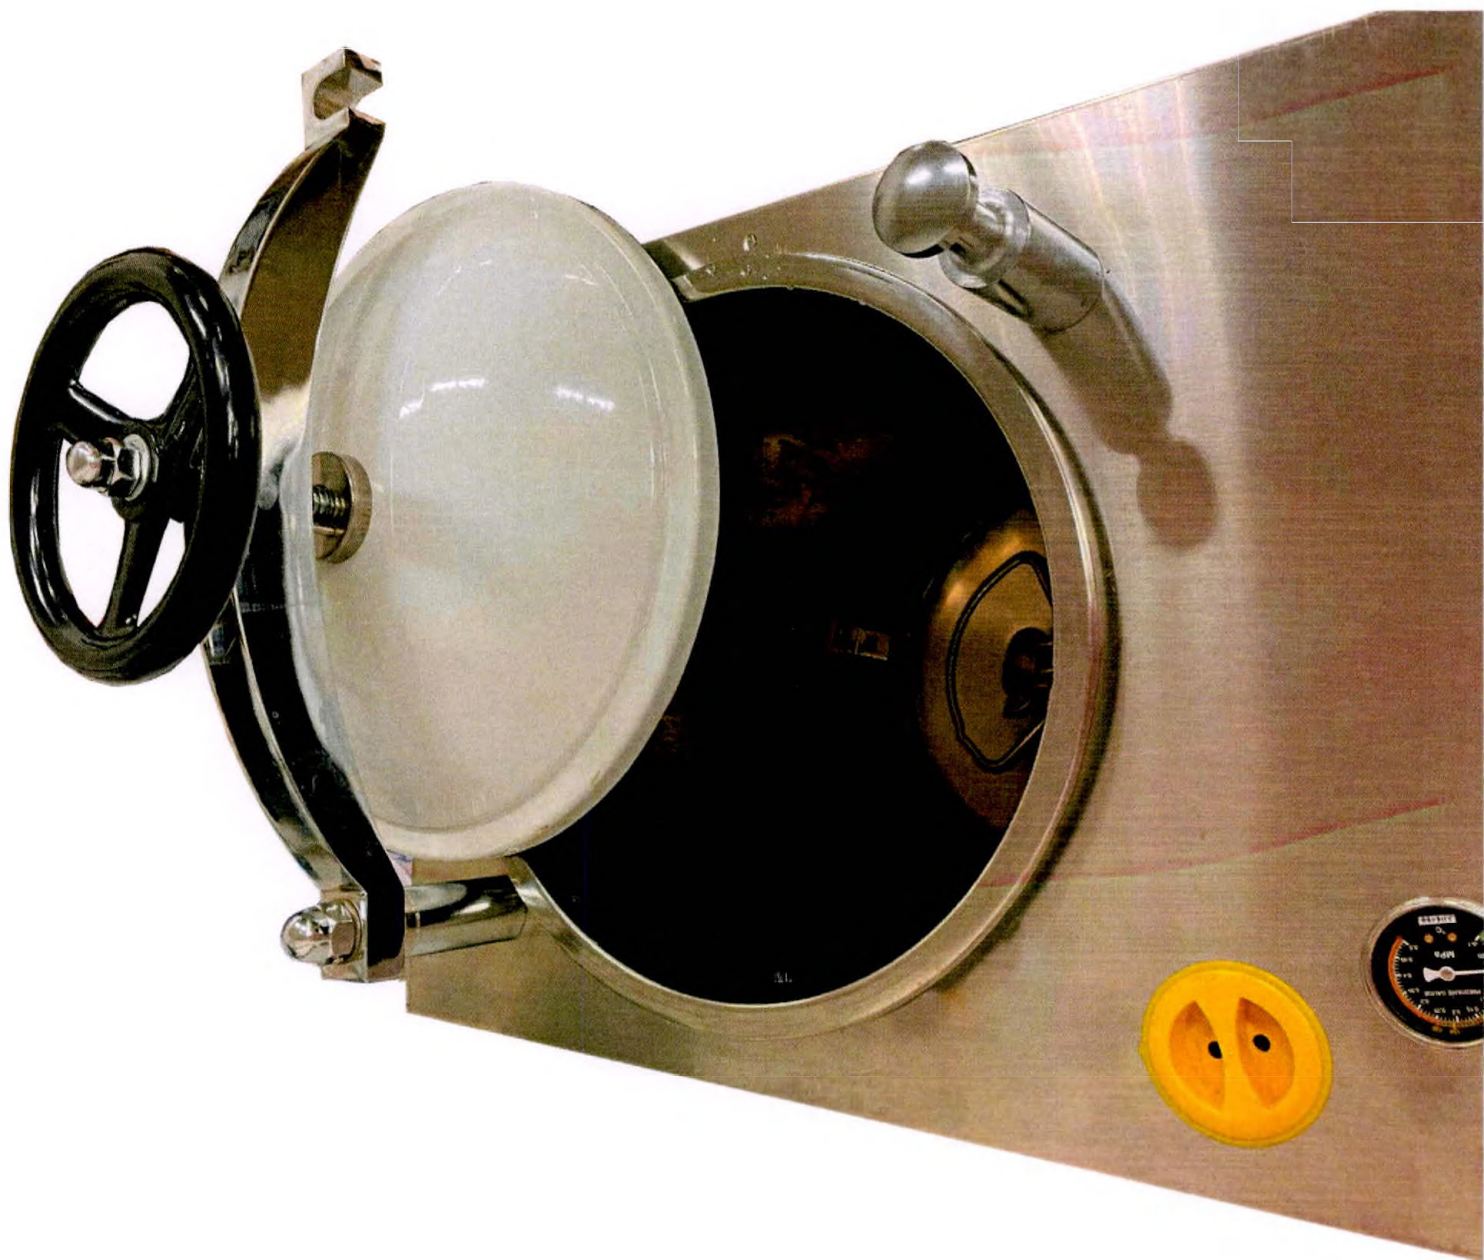





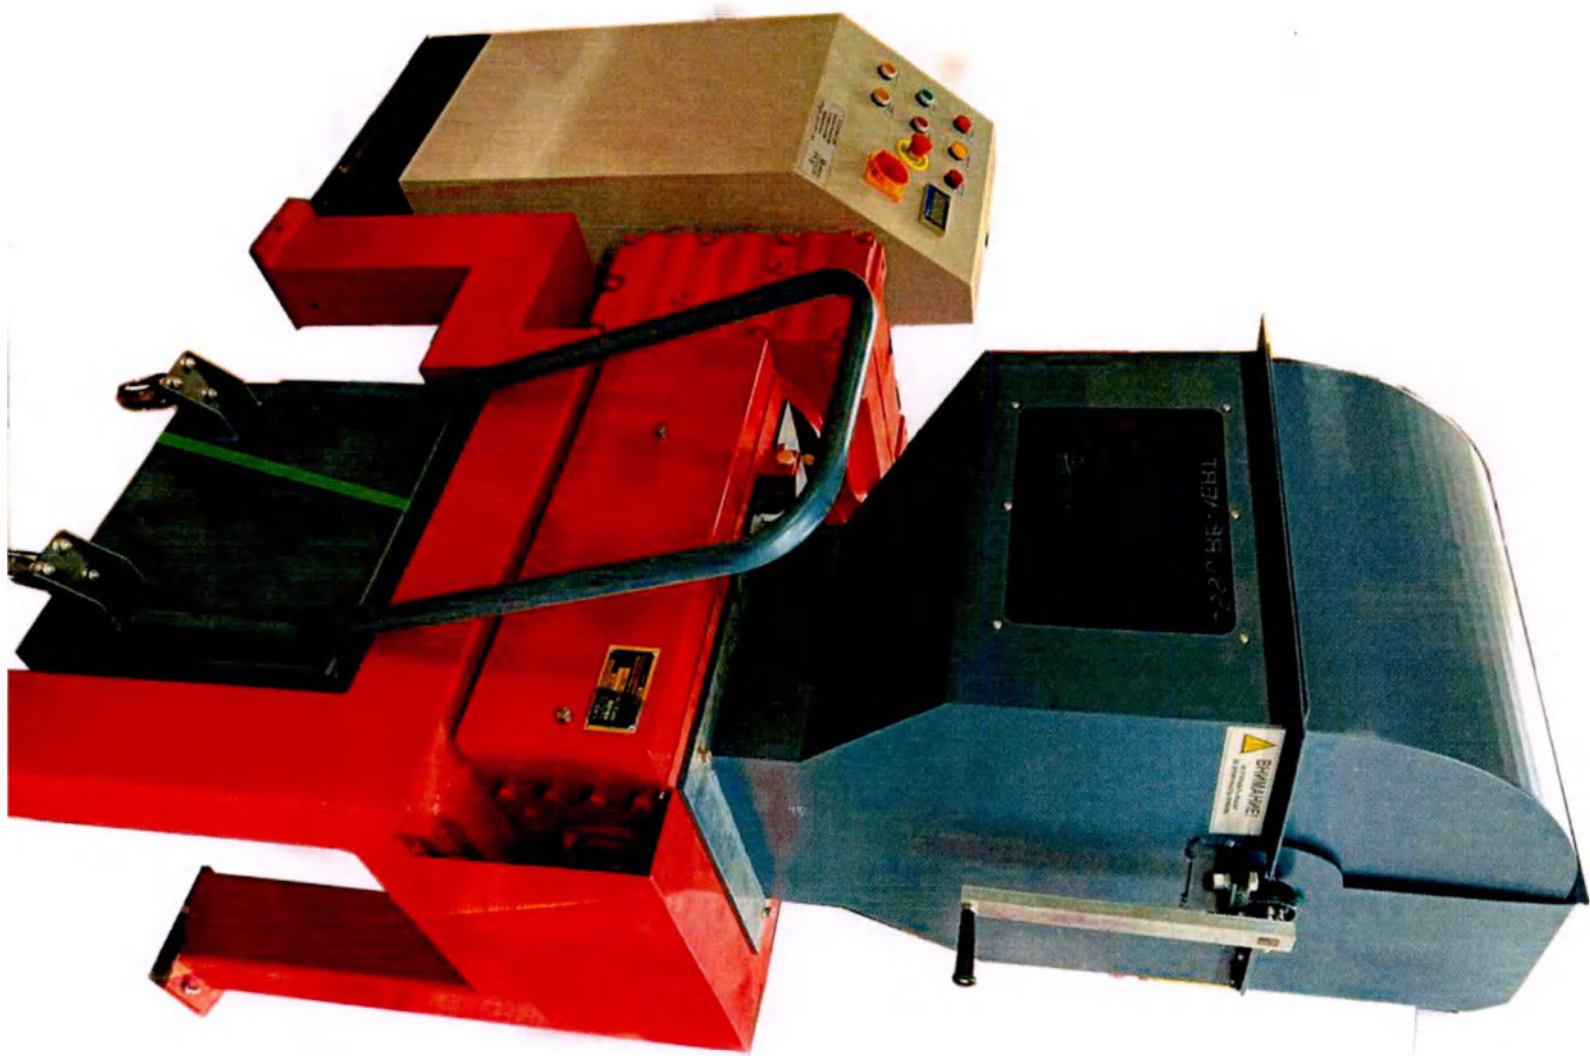




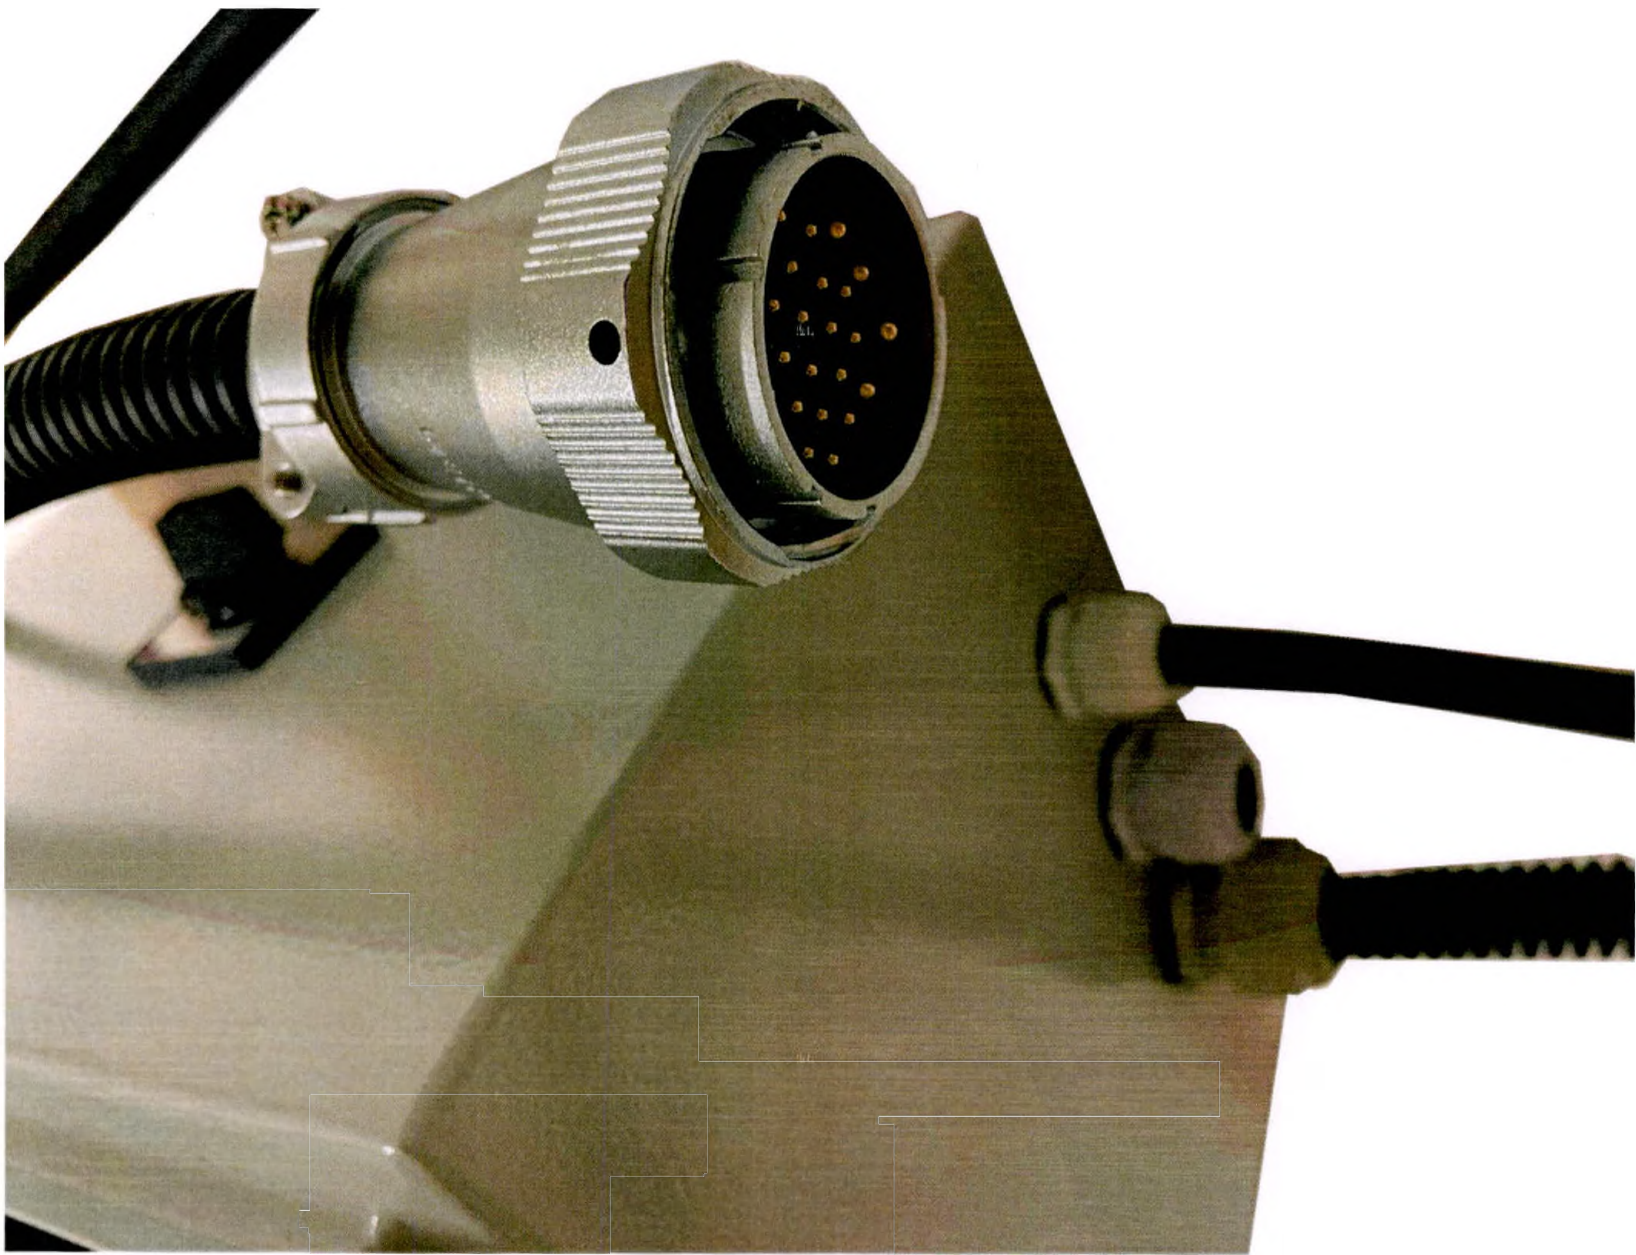

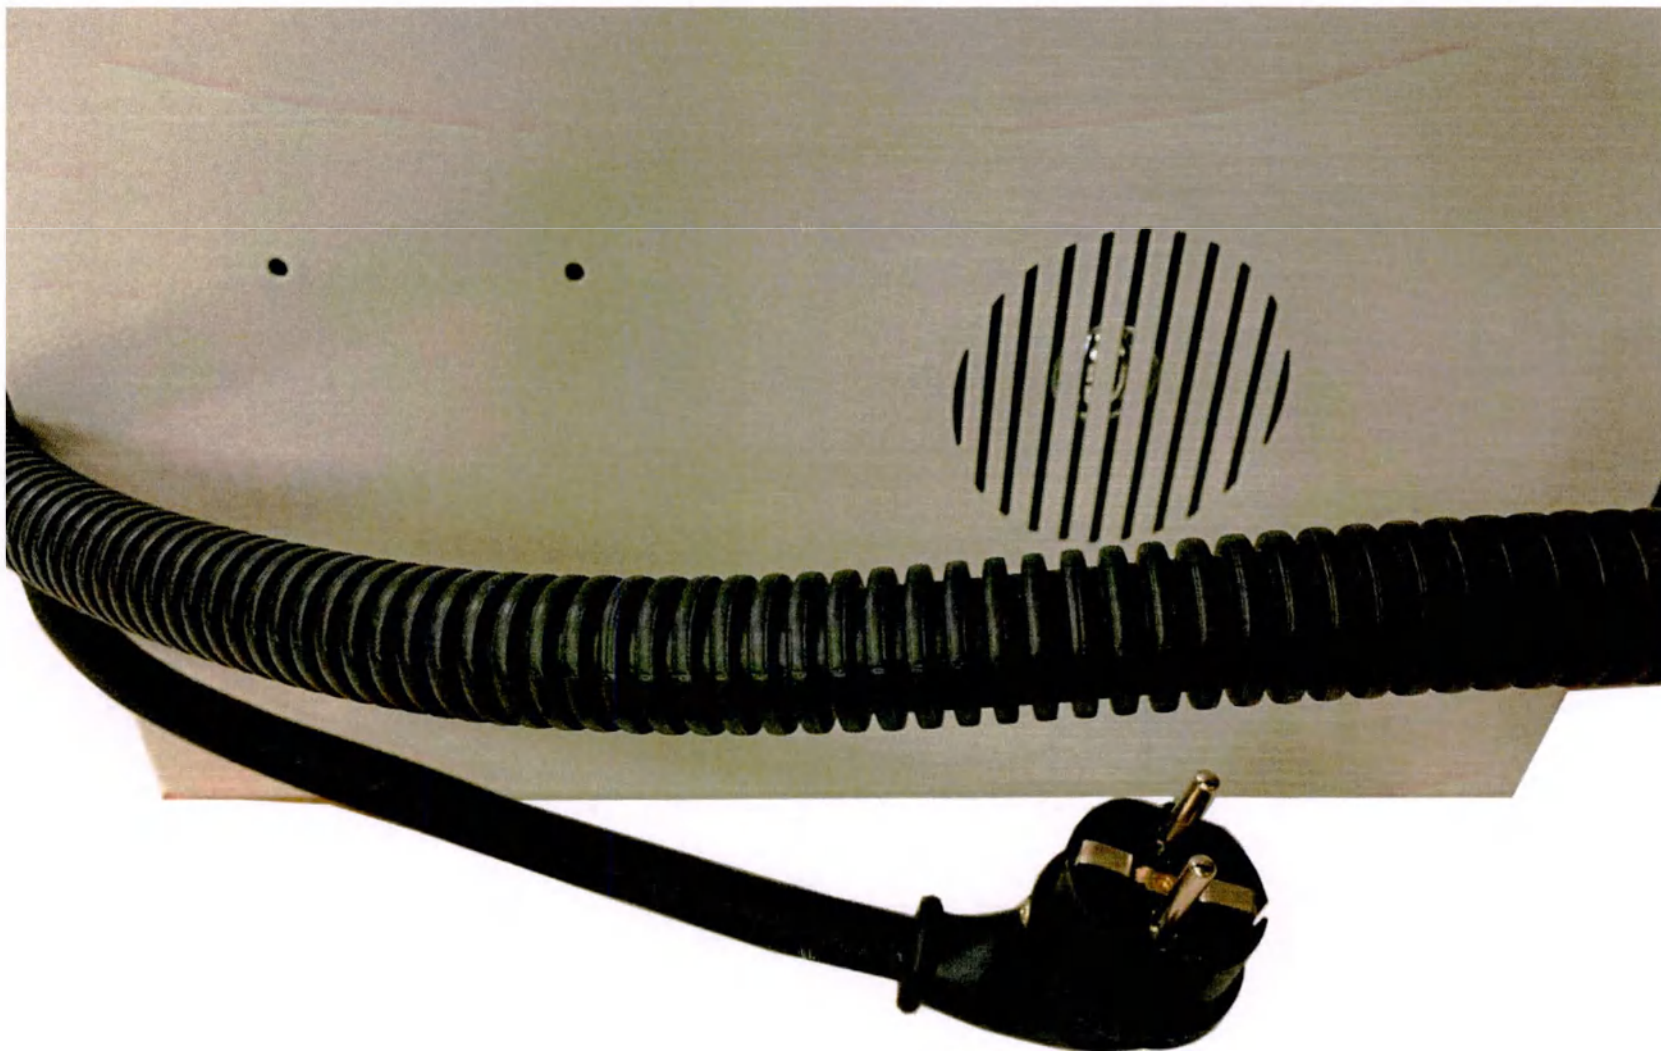

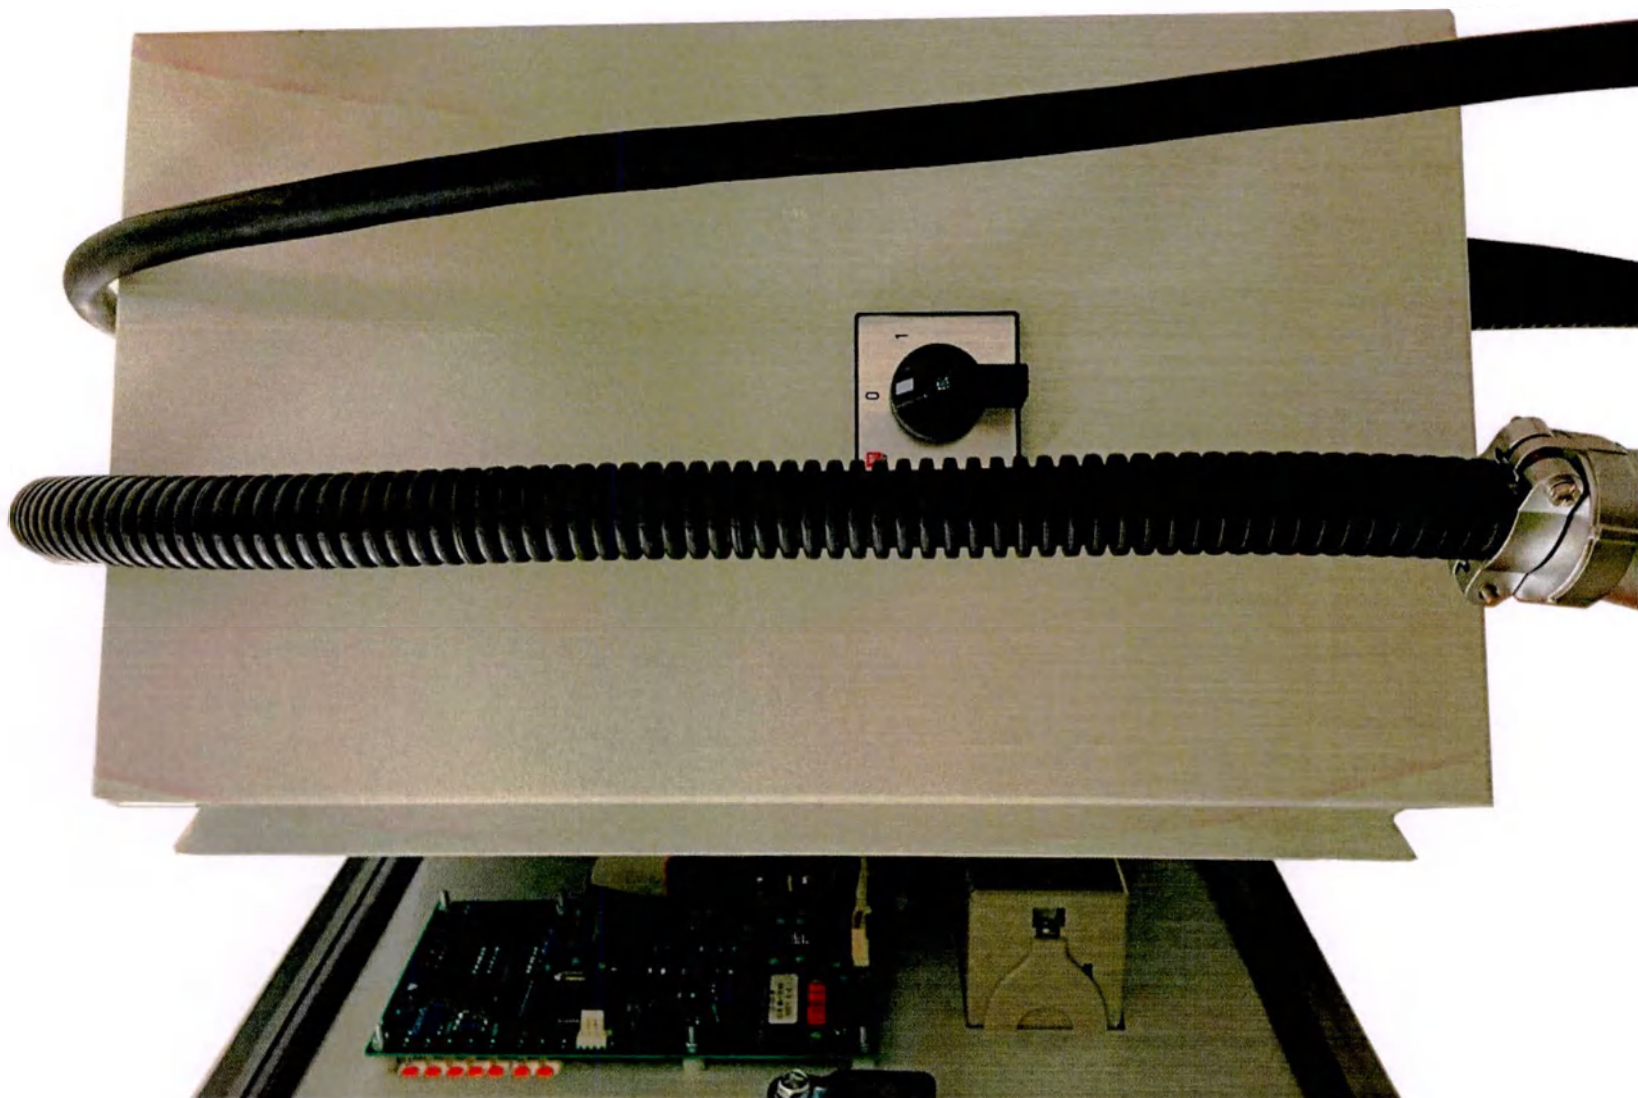


Блок управления модуль 4

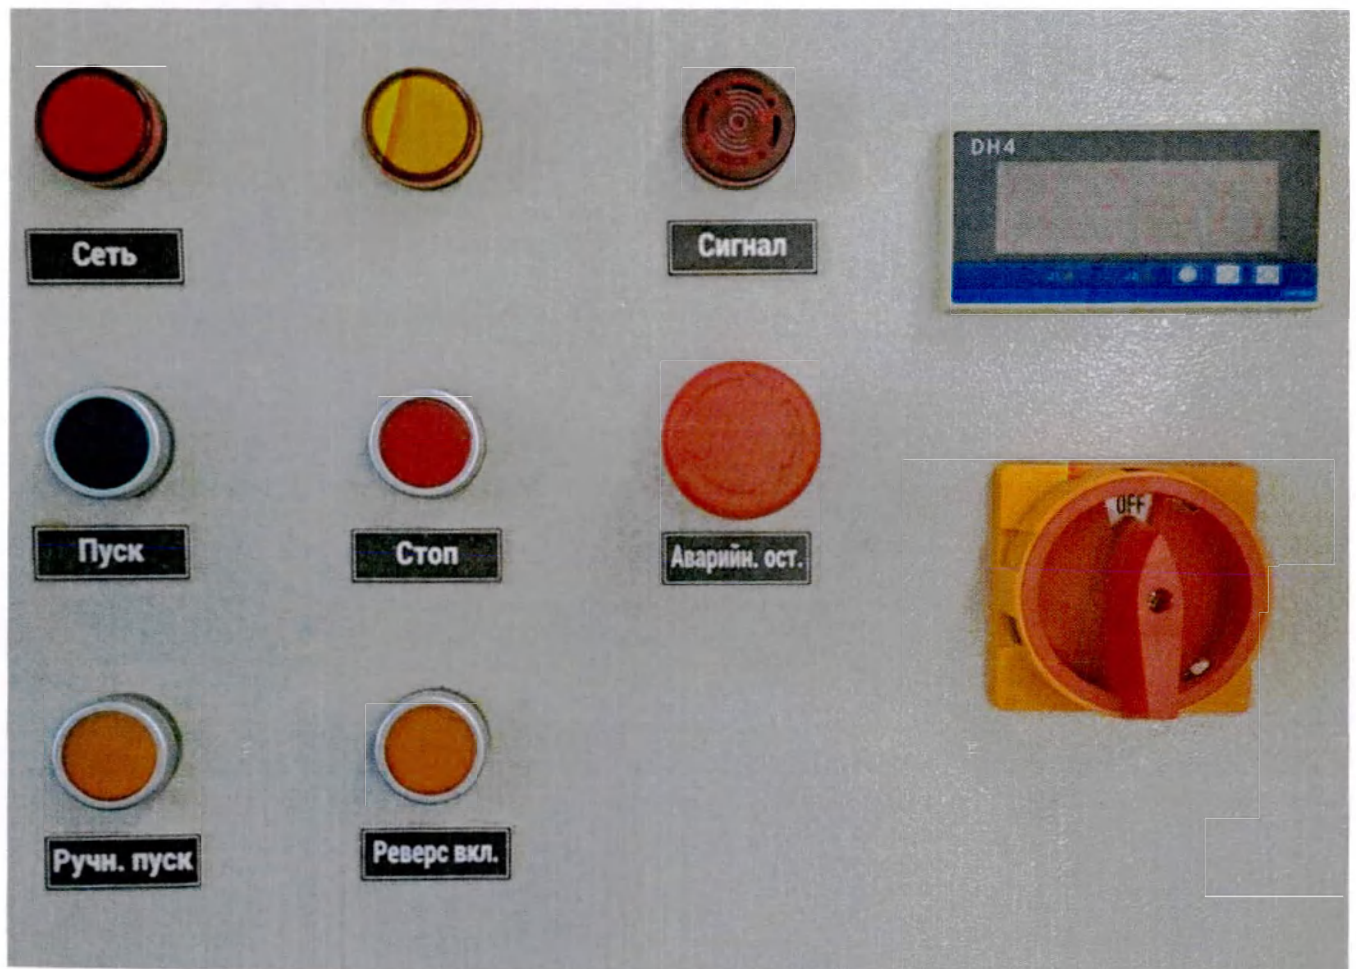

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш30 Б»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш30 Б»

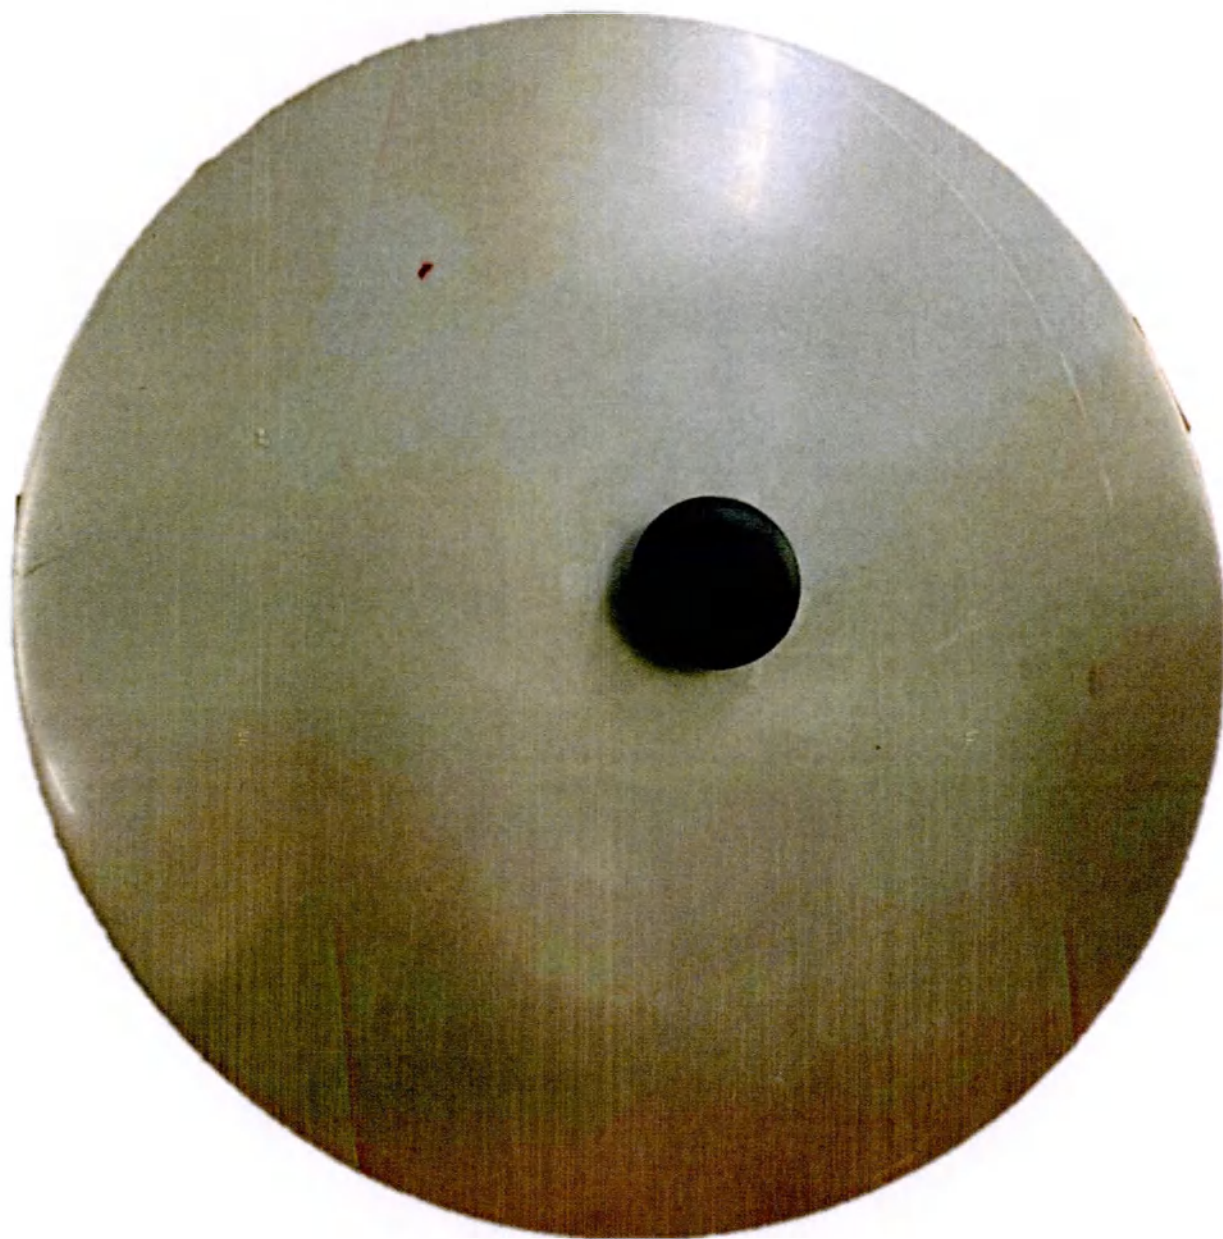

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш30 Б»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



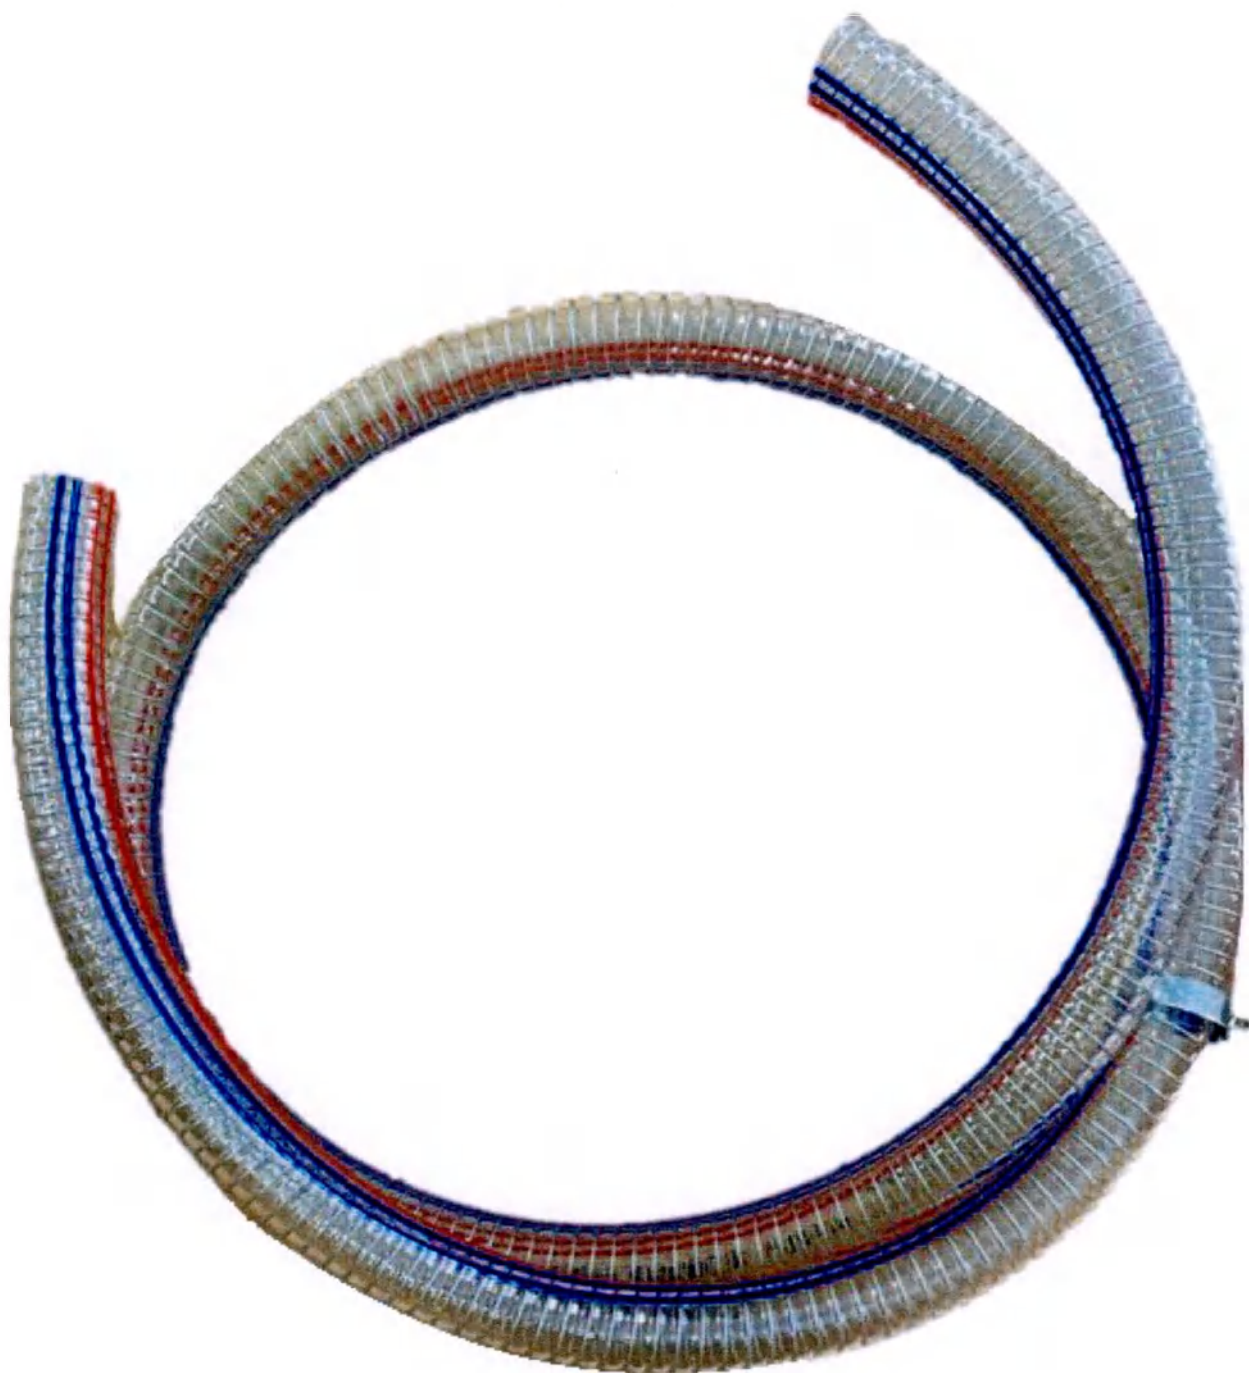

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-30

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-30

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 2,5 кВА
Объем стерилизационной камеры: 30 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 SN 00116

 ПУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Шредер Б модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

 07.2023 г.
 SN 00116

 ПУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш30 Б»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш30 Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.

SN


00116


8. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш150 Б»

Автоклав модуль 1-50





Камера автоклава модуль 1-50

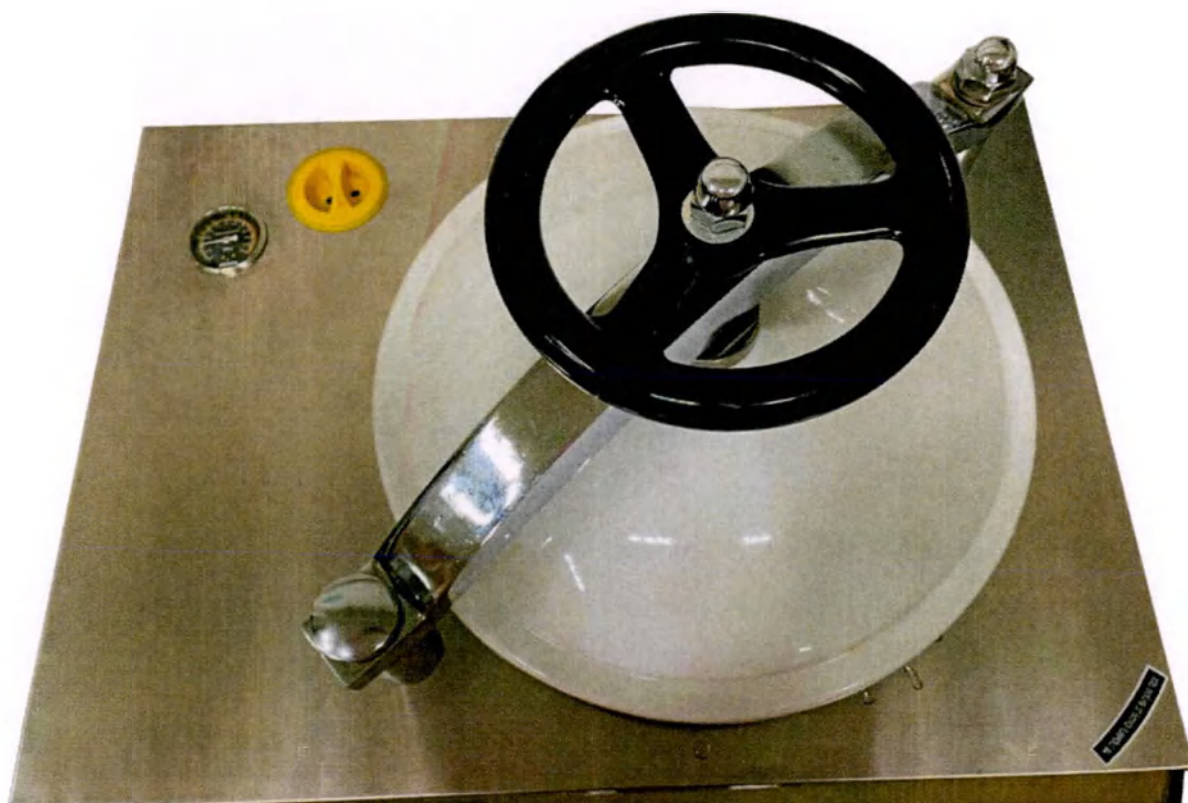

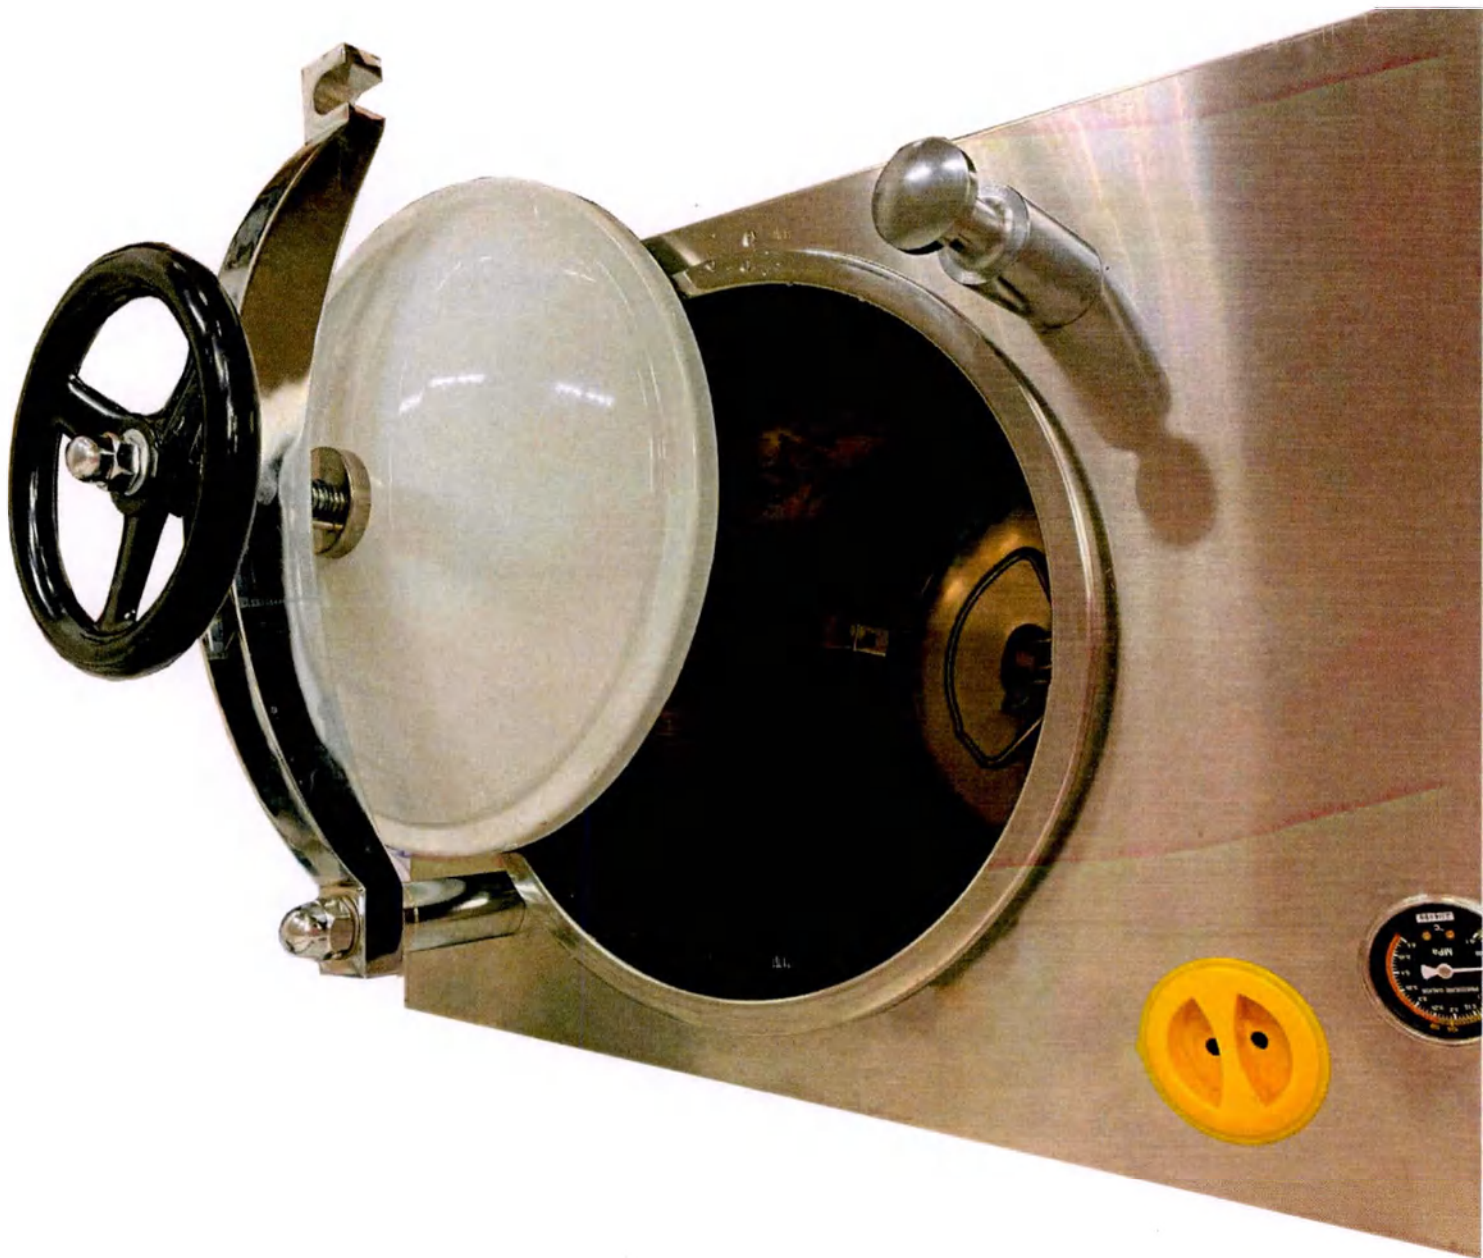



Шредер Б модуль 2

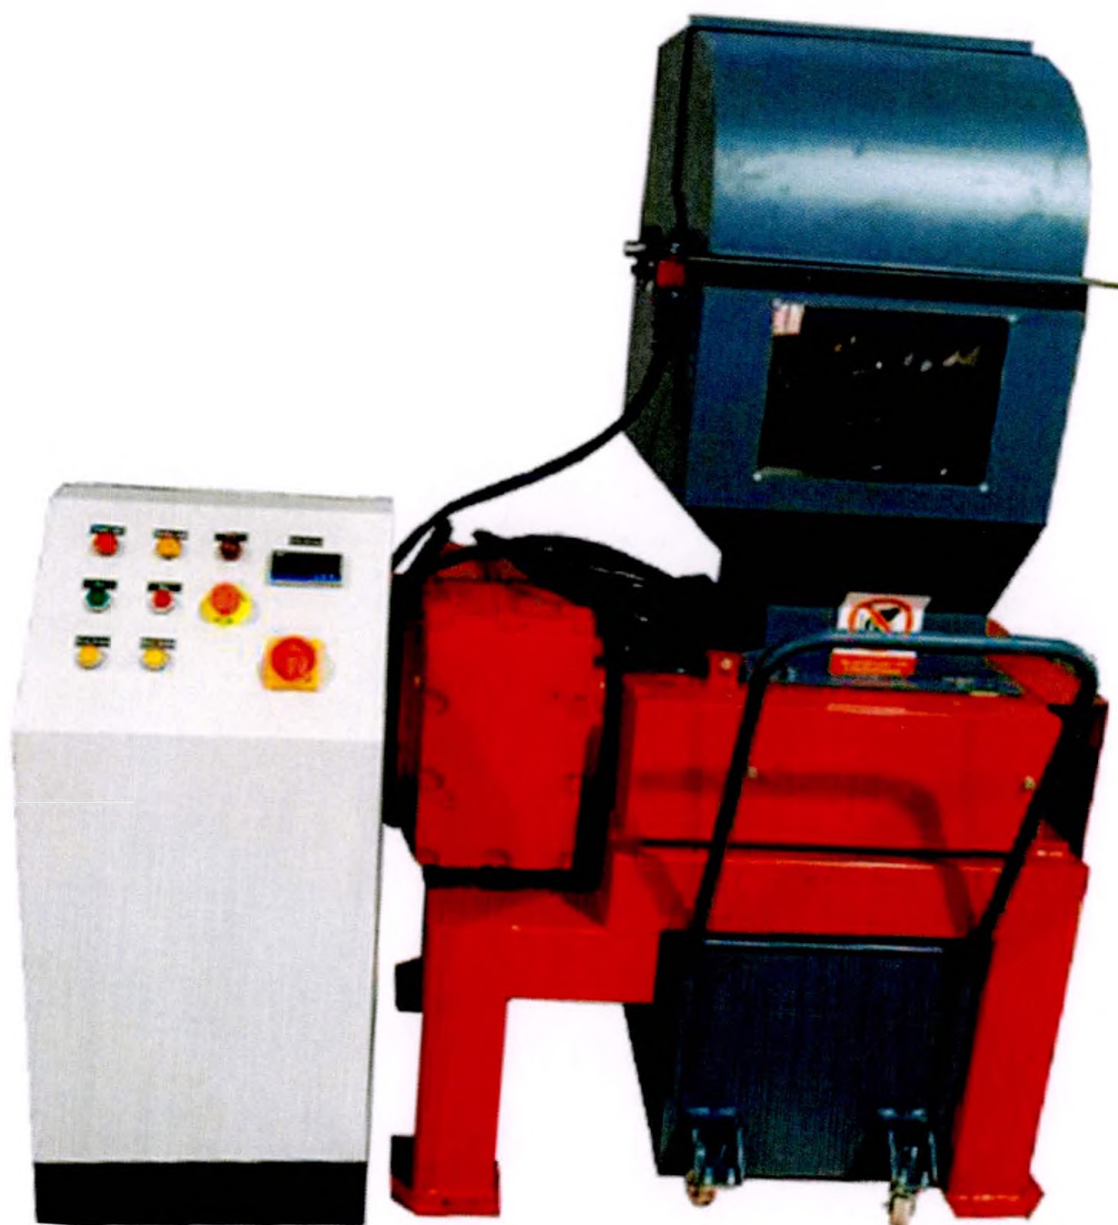


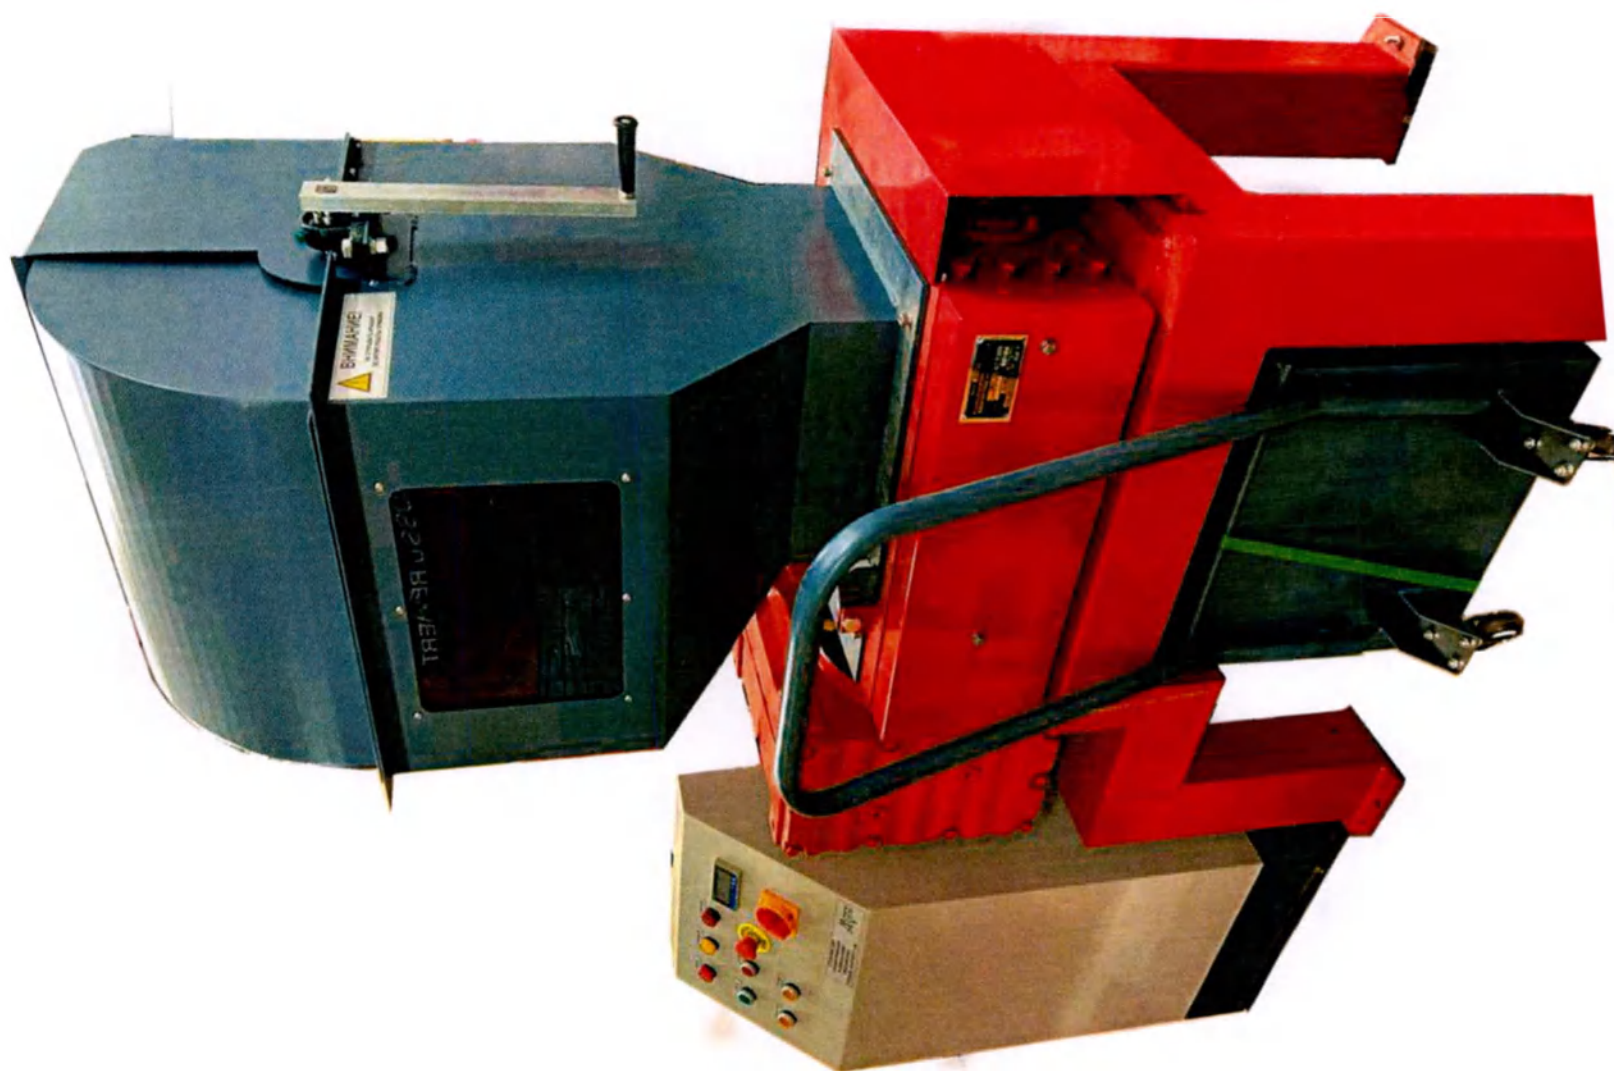




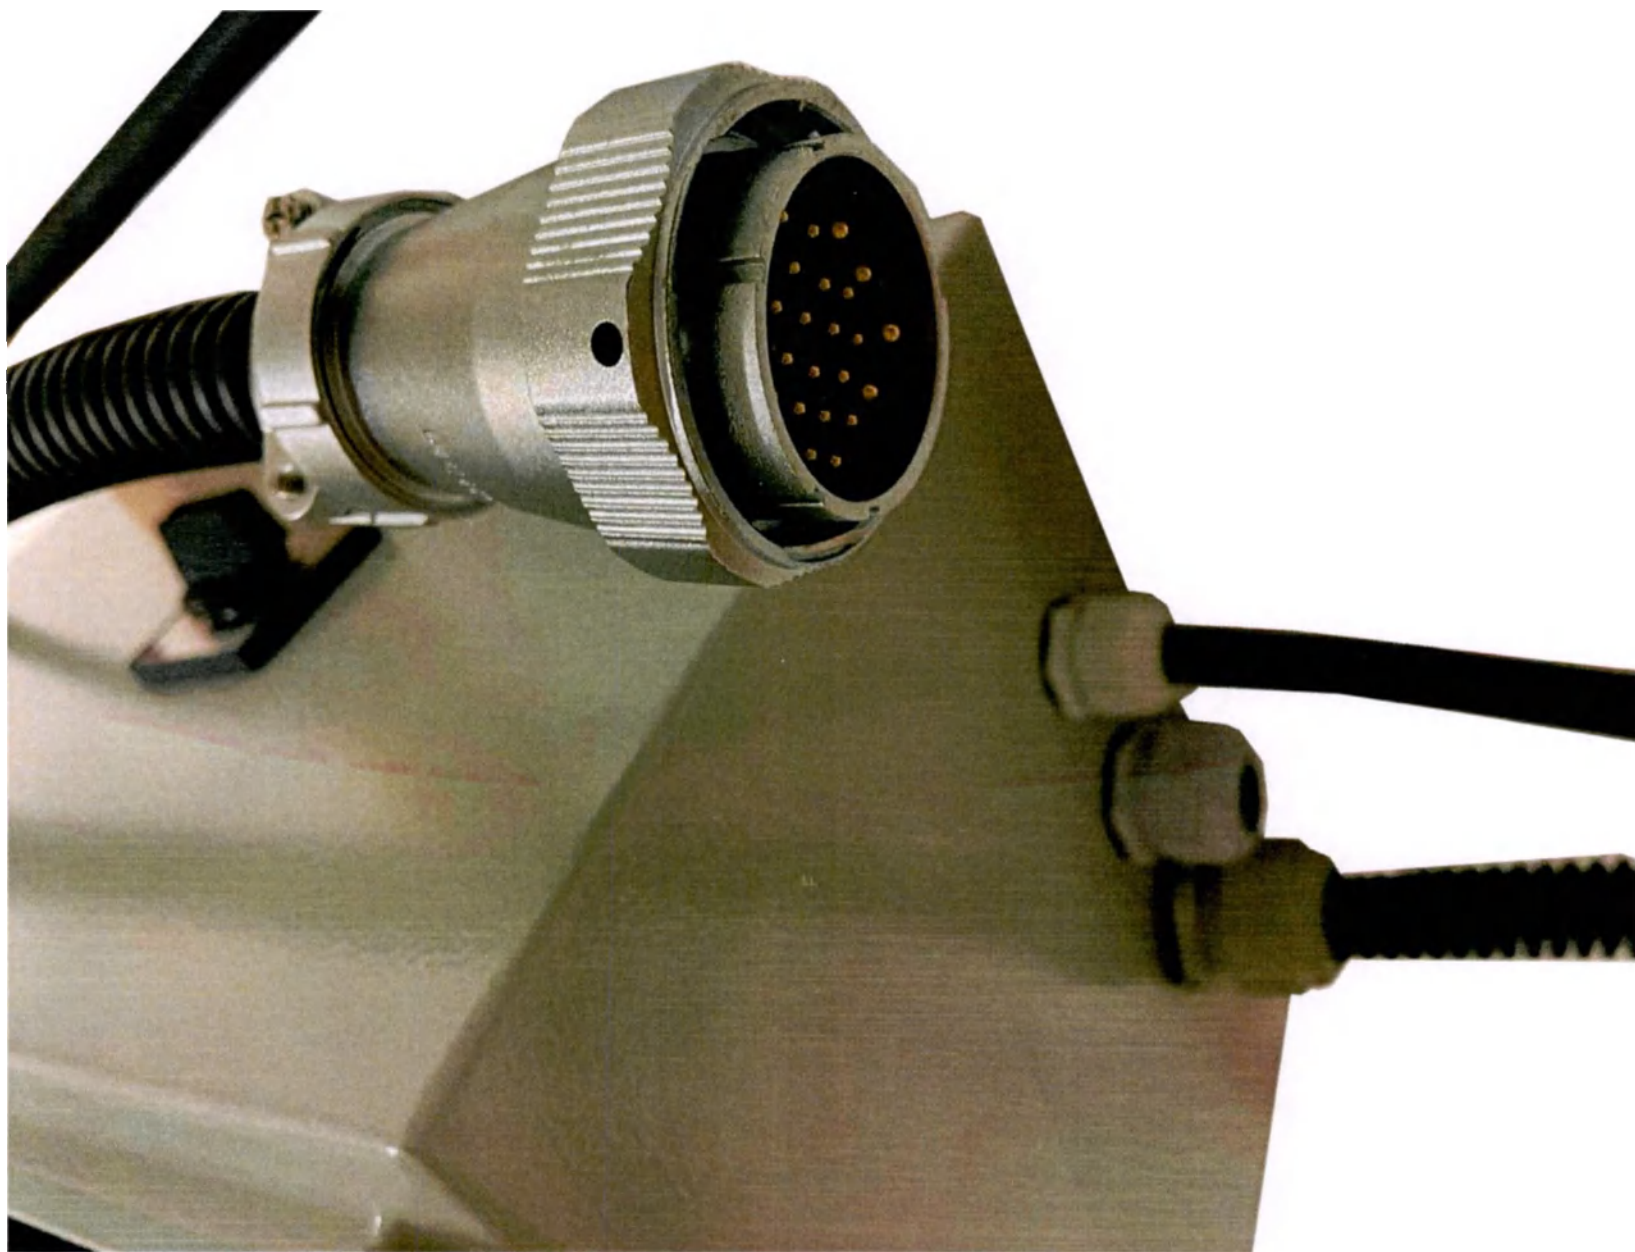

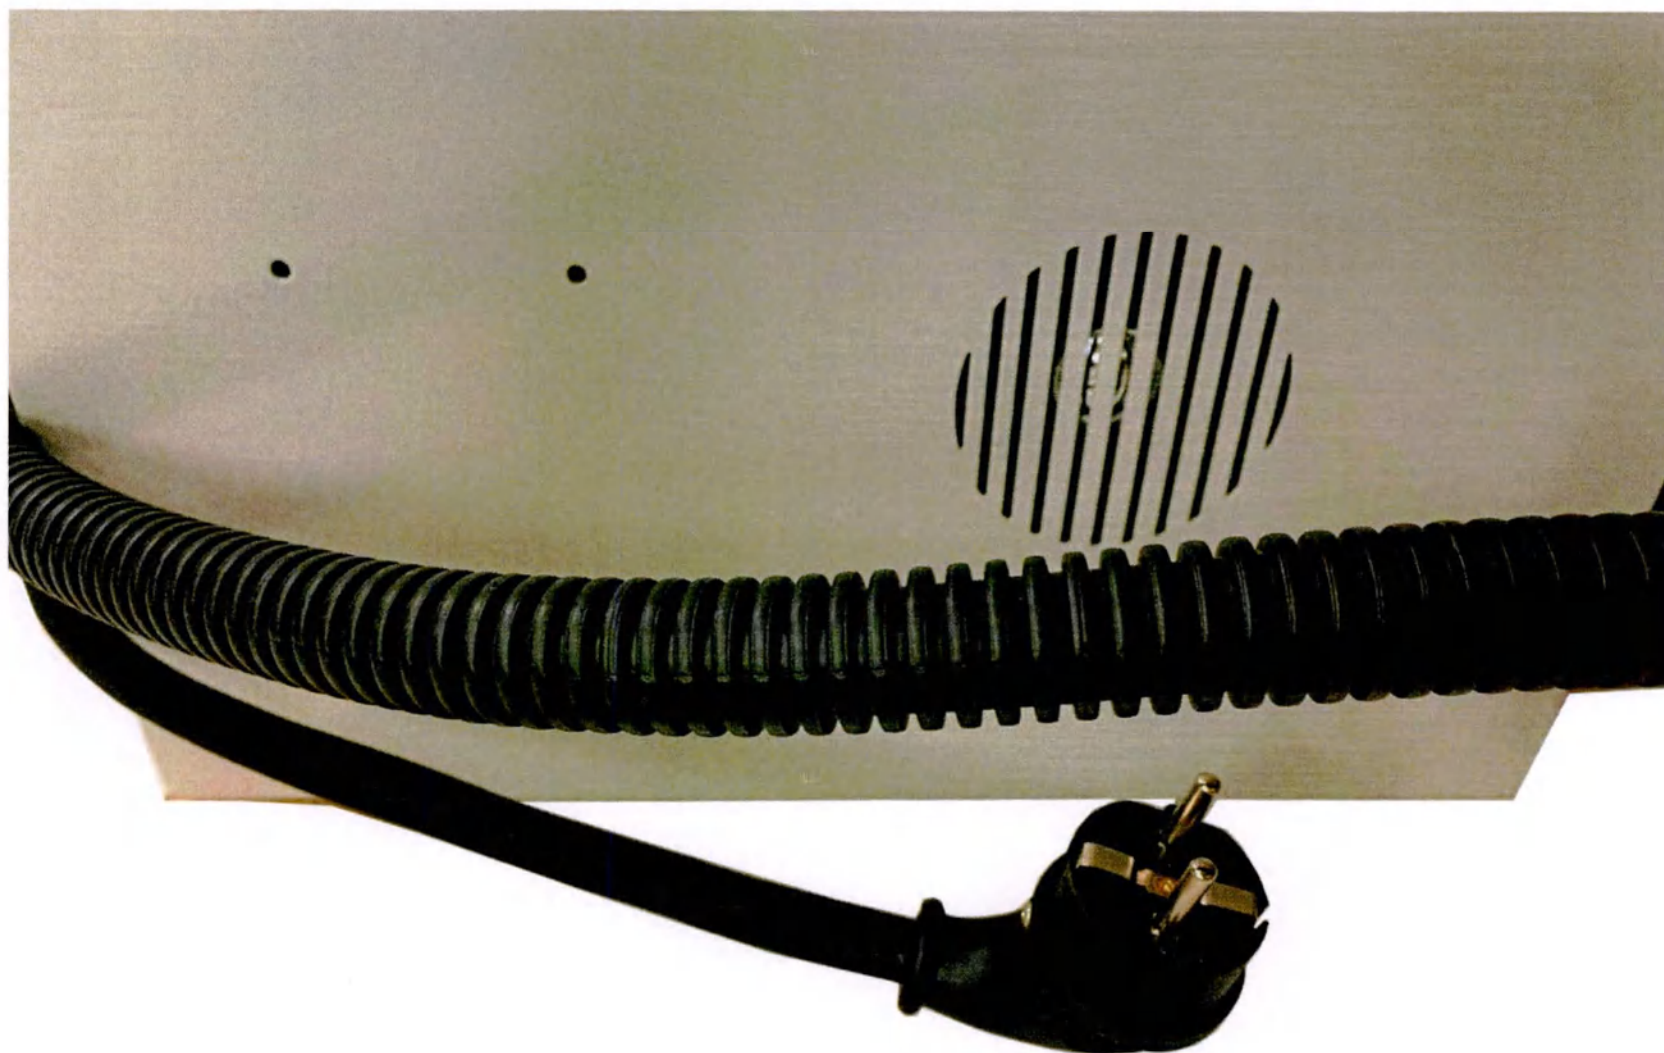

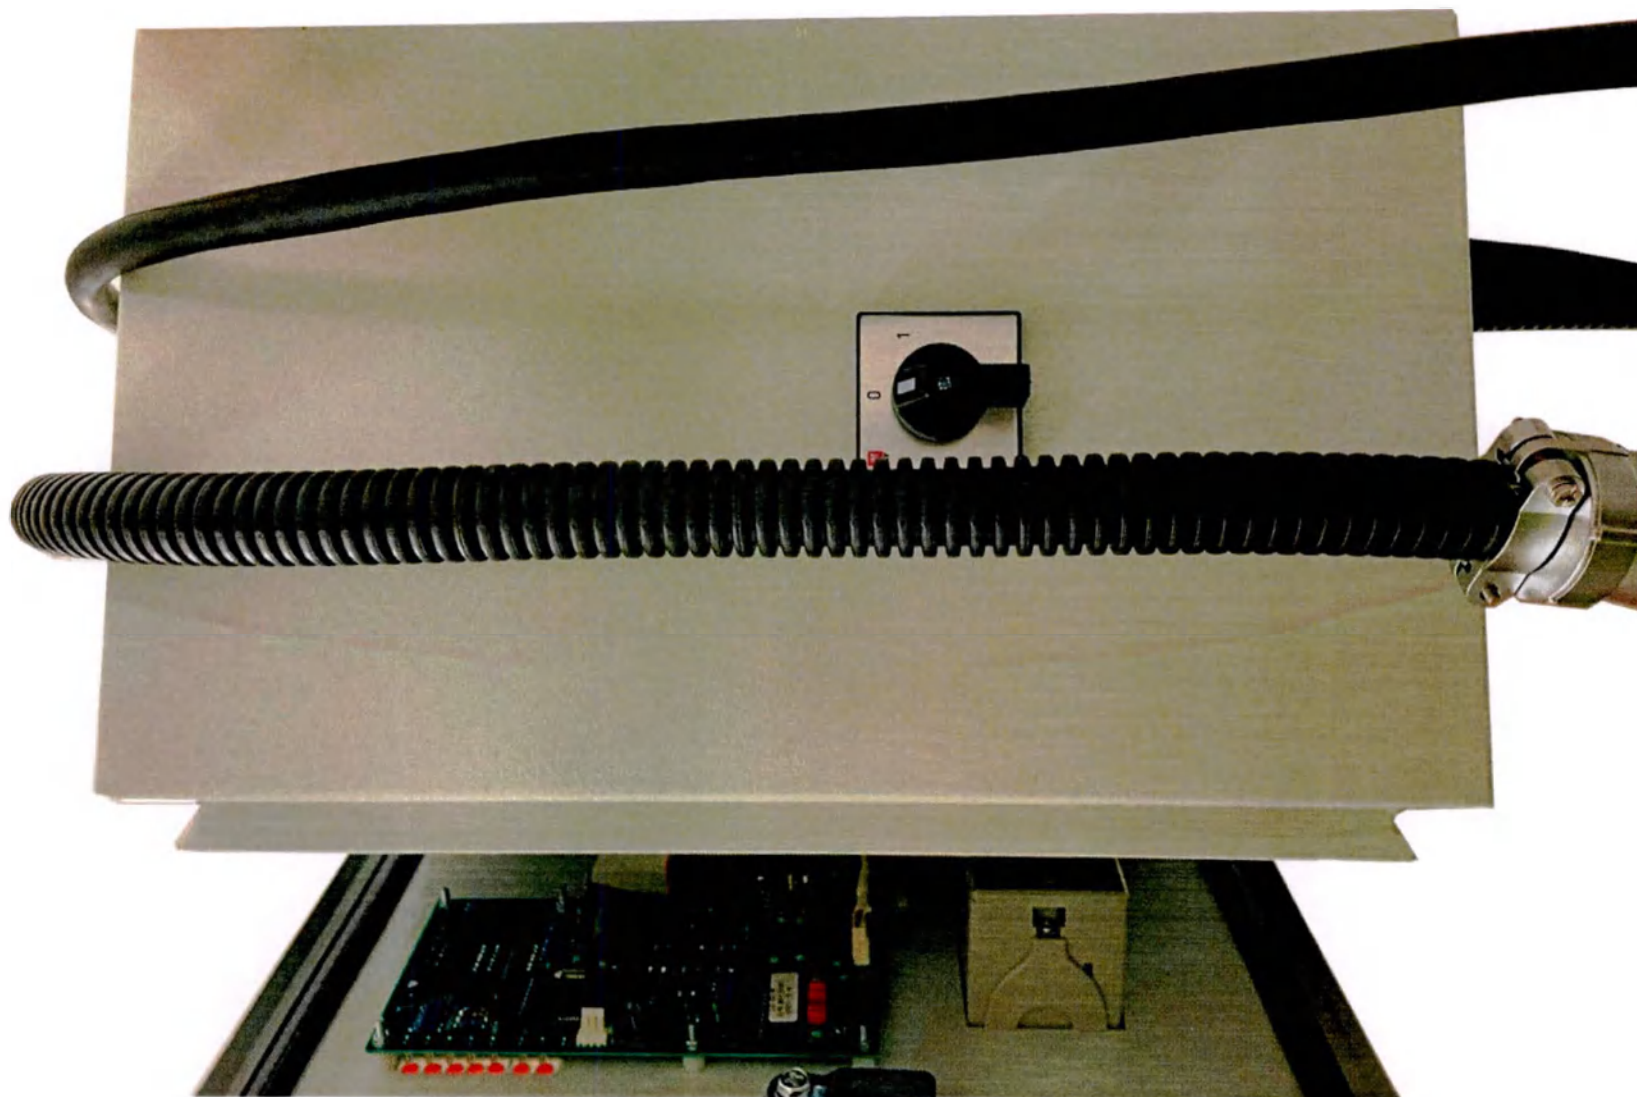


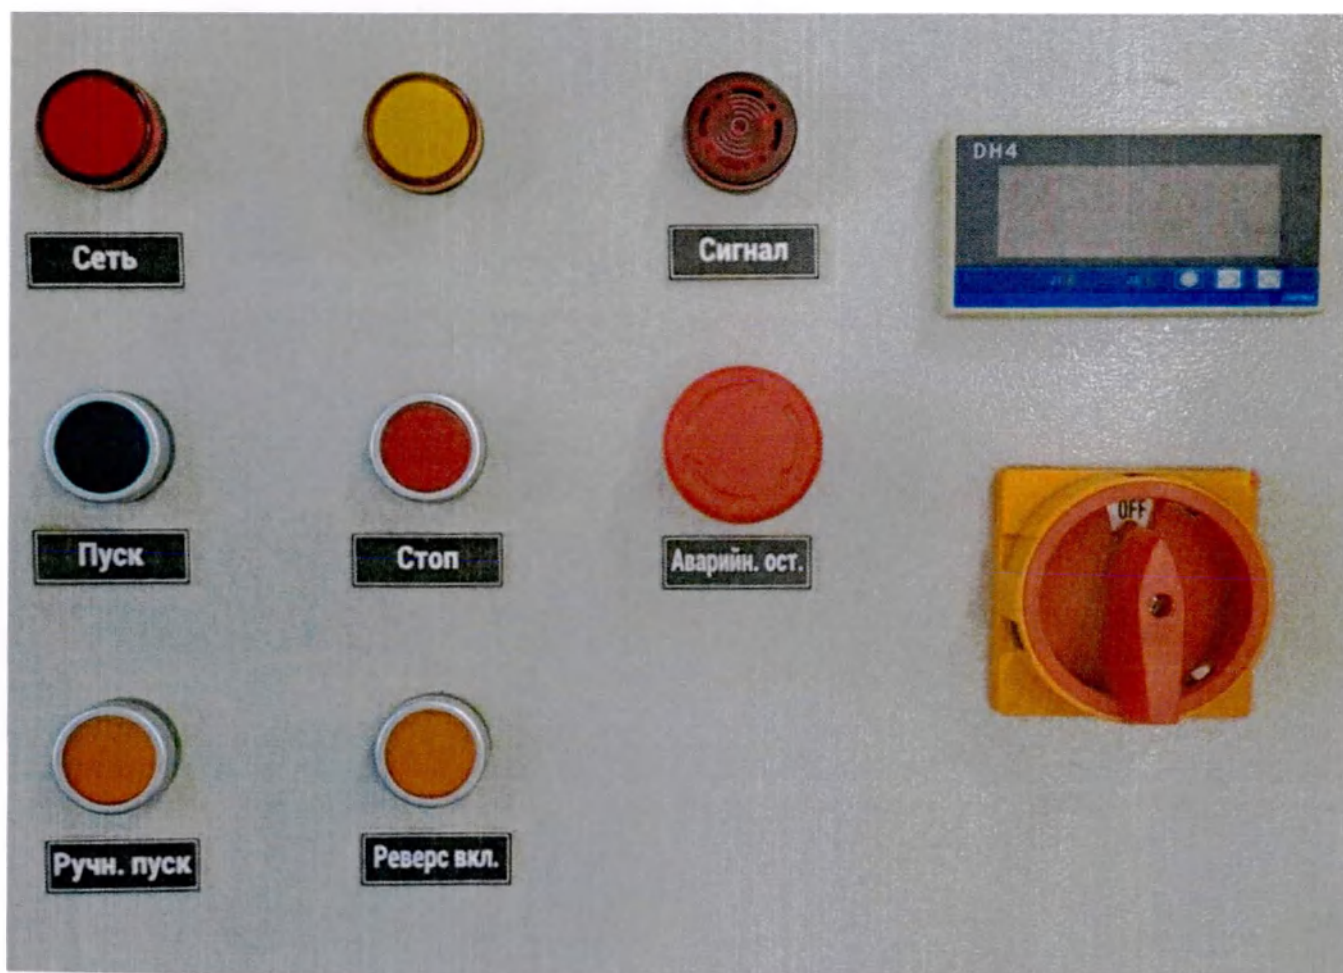


Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш50 Б»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш50 Б»

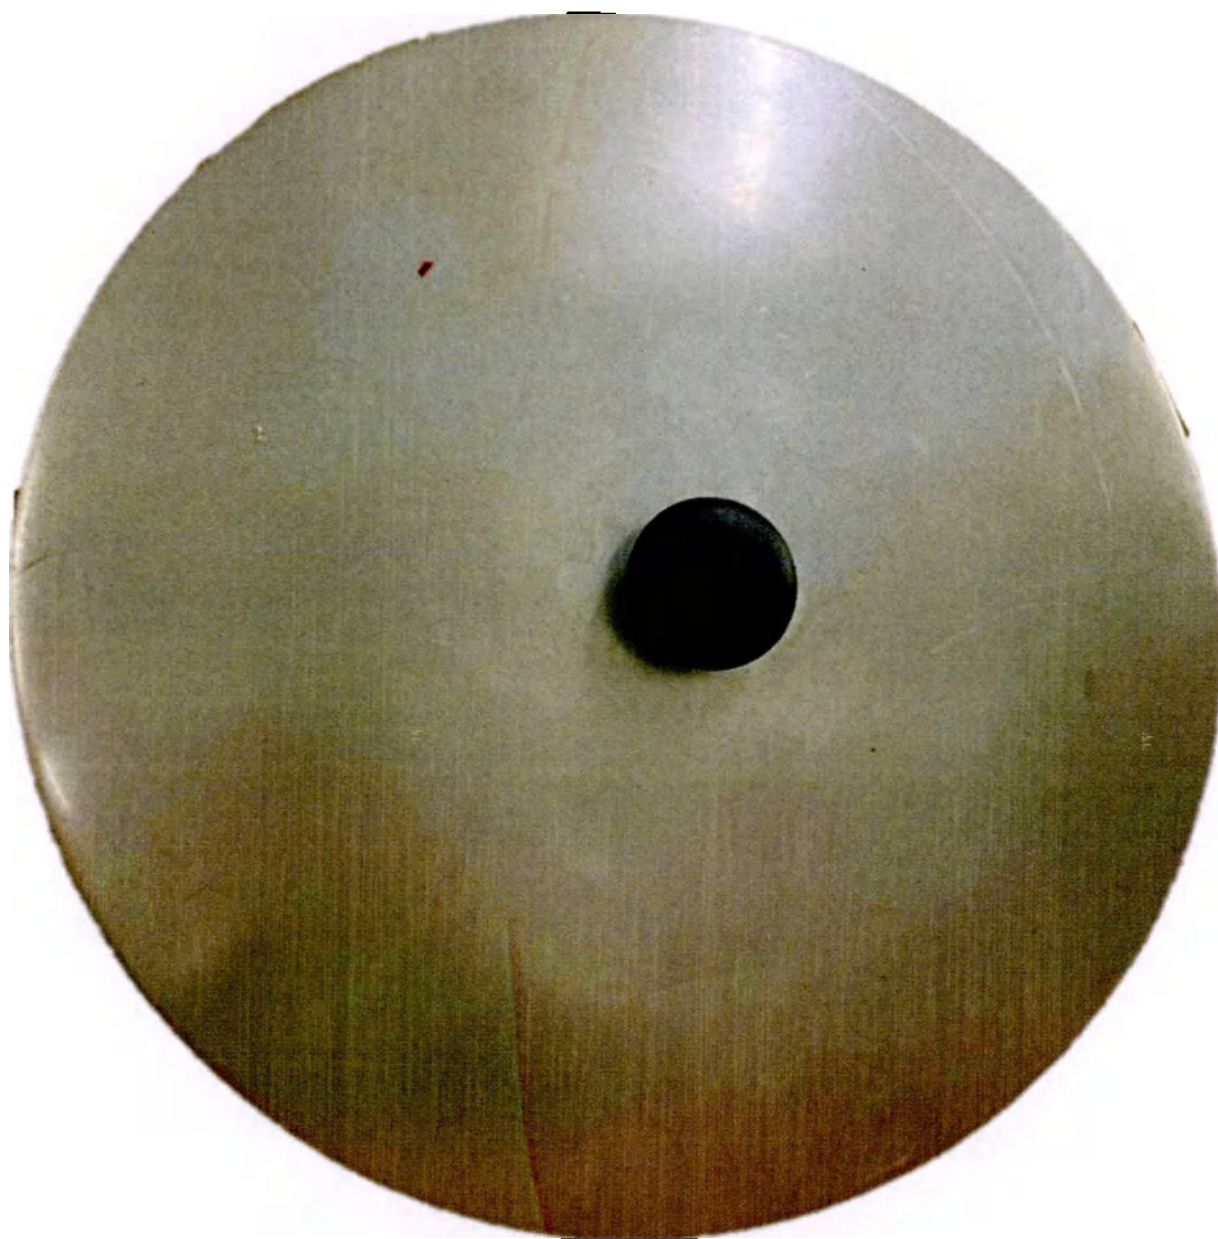


Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш50 Б»

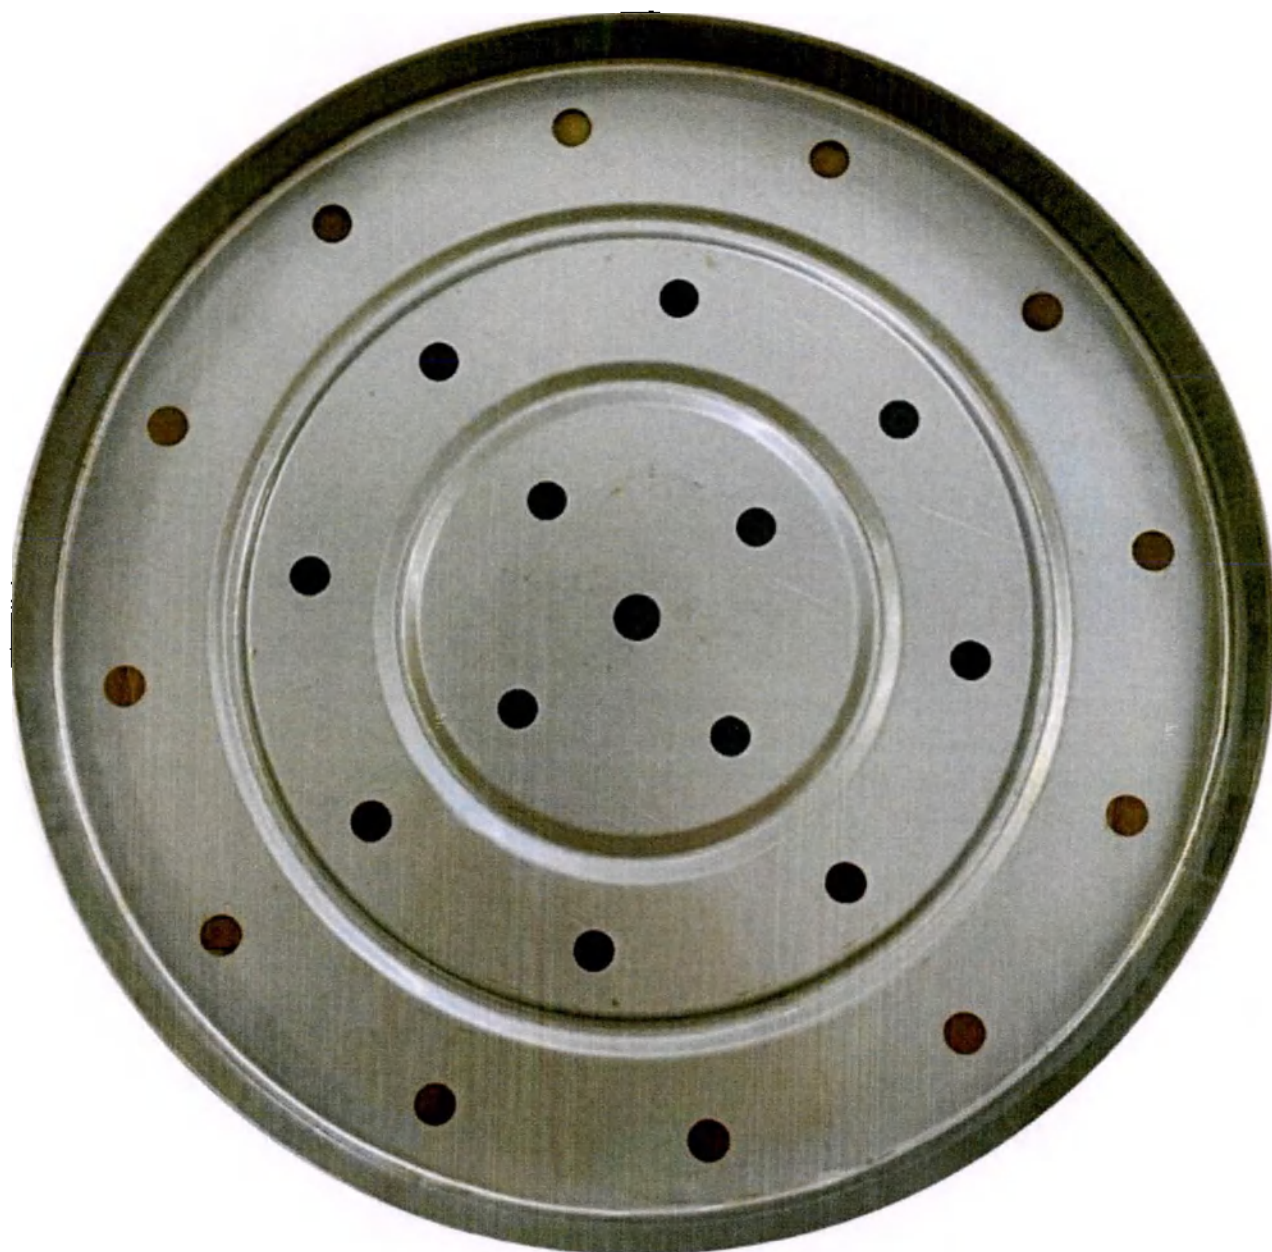



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



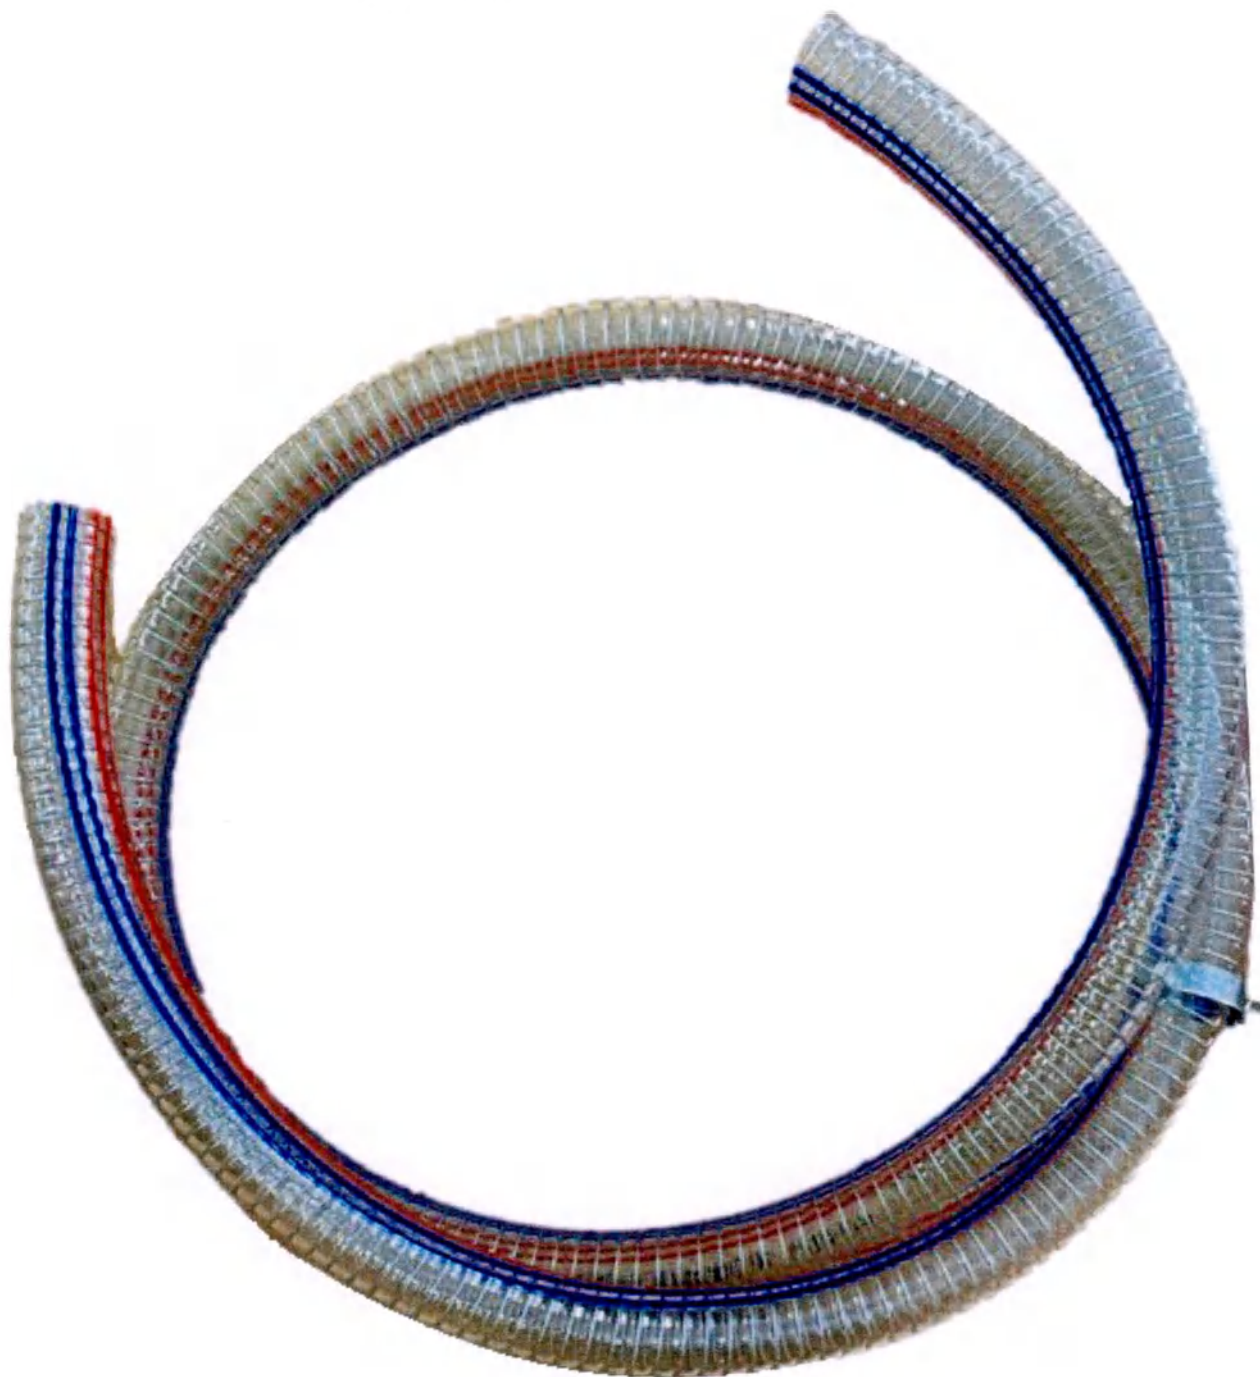



Маркировка Автоклав модуль 1-50

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-50

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 50 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 00117

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Шредер Б модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3 ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

 07.2023 г.
 00117

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш50 Б»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш50 Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг
Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00117


9. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»

Автоклав модуль 1-100




Камера автоклава модуль 1-100

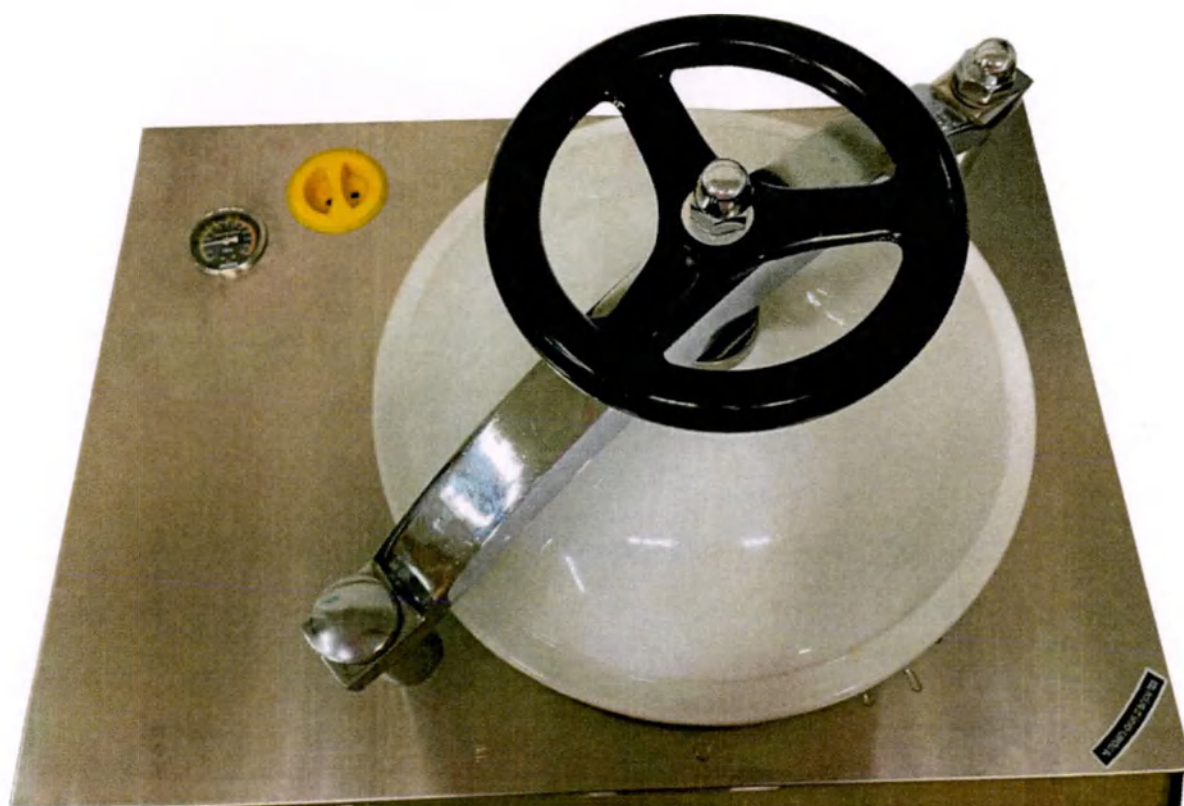

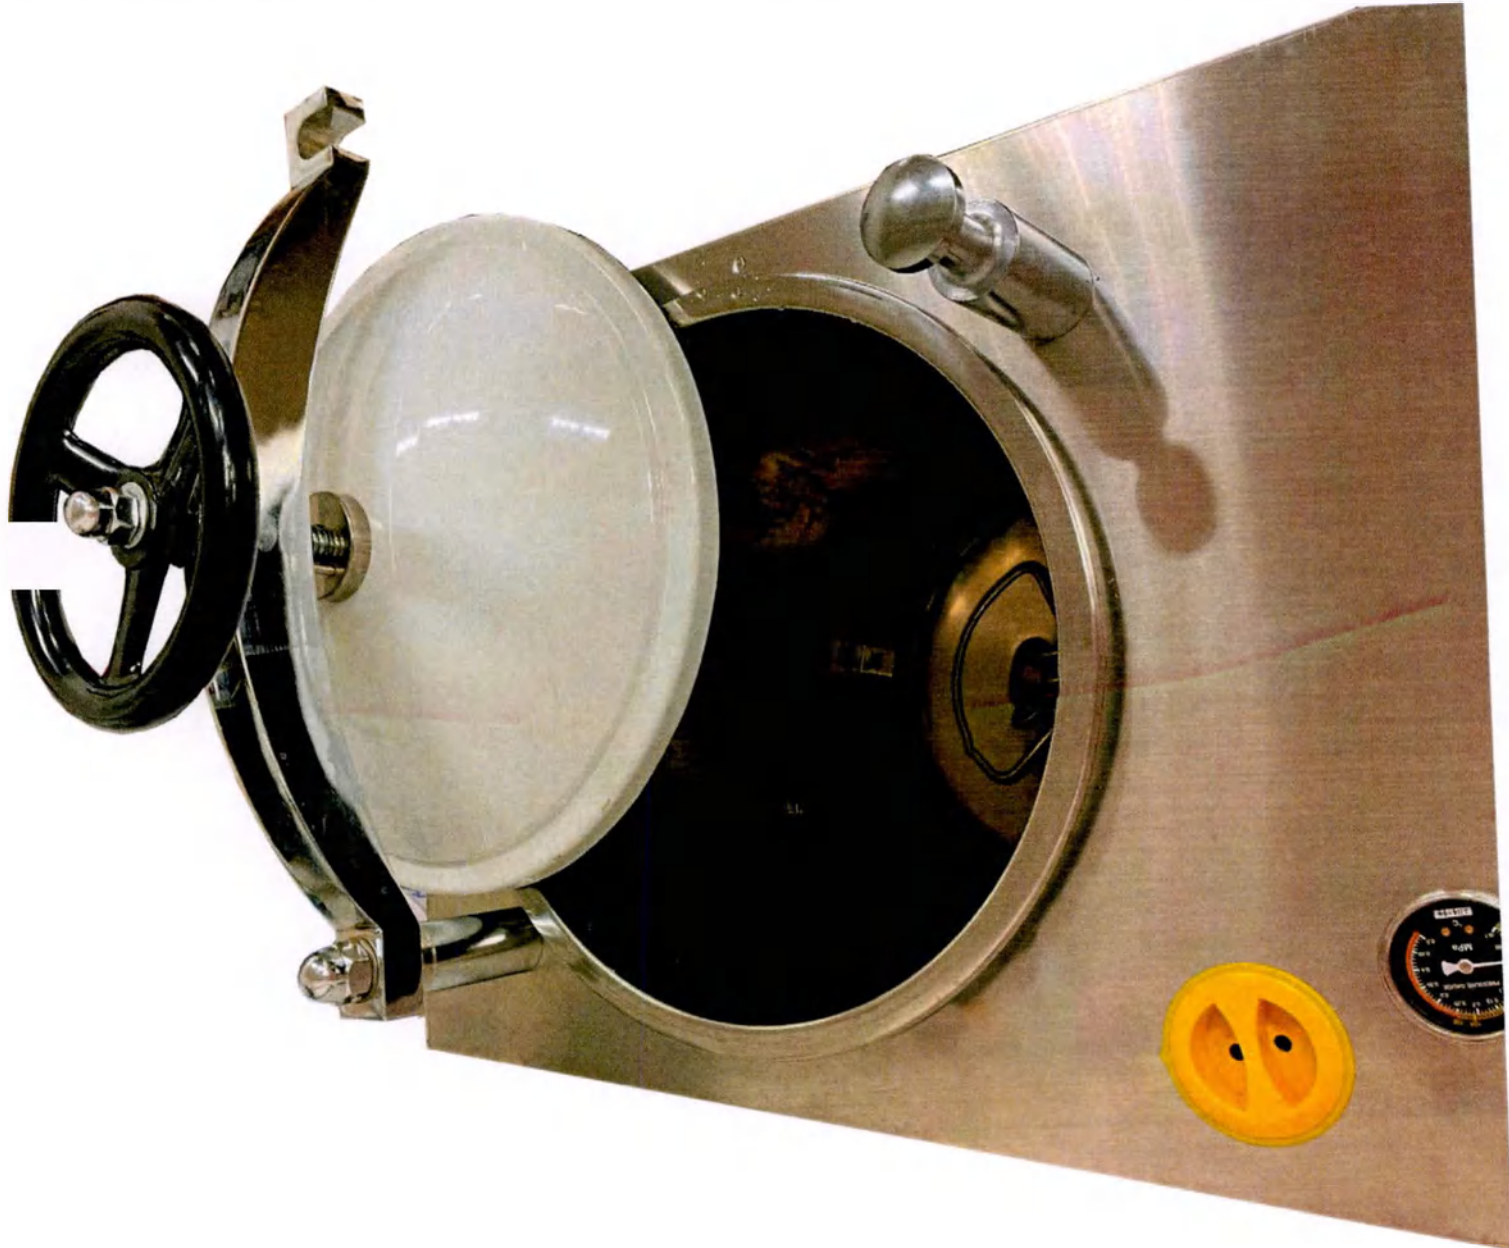


Шредер Б модуль 2




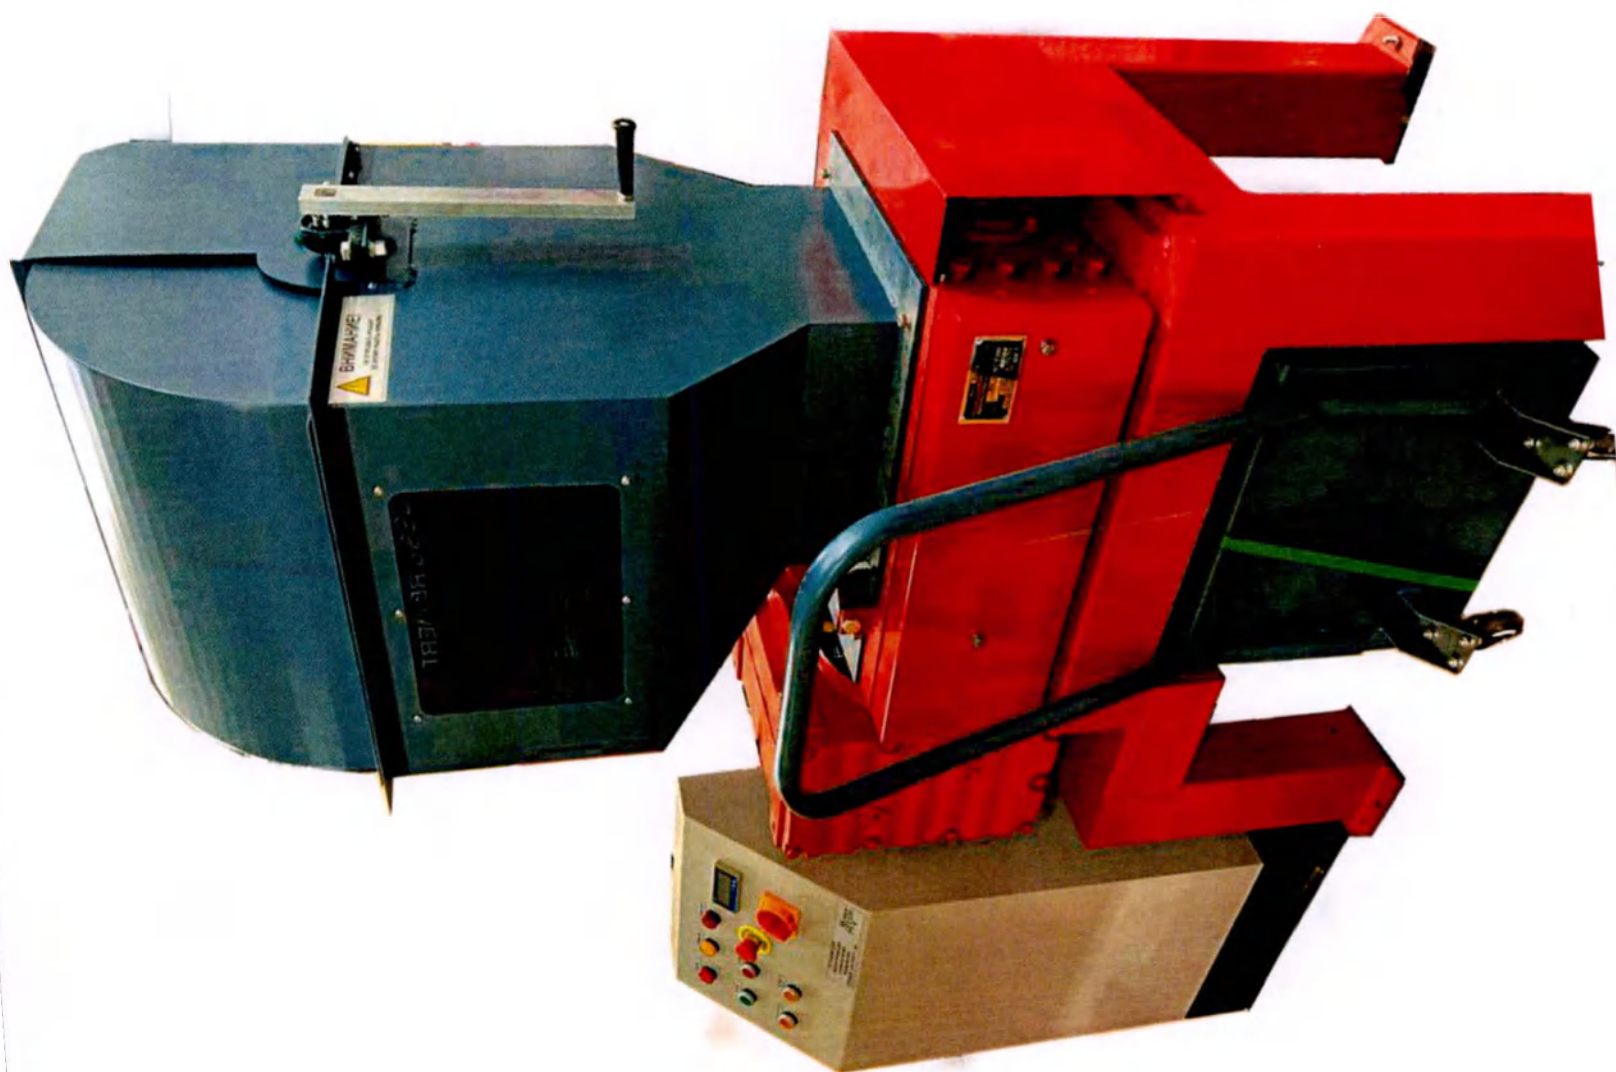






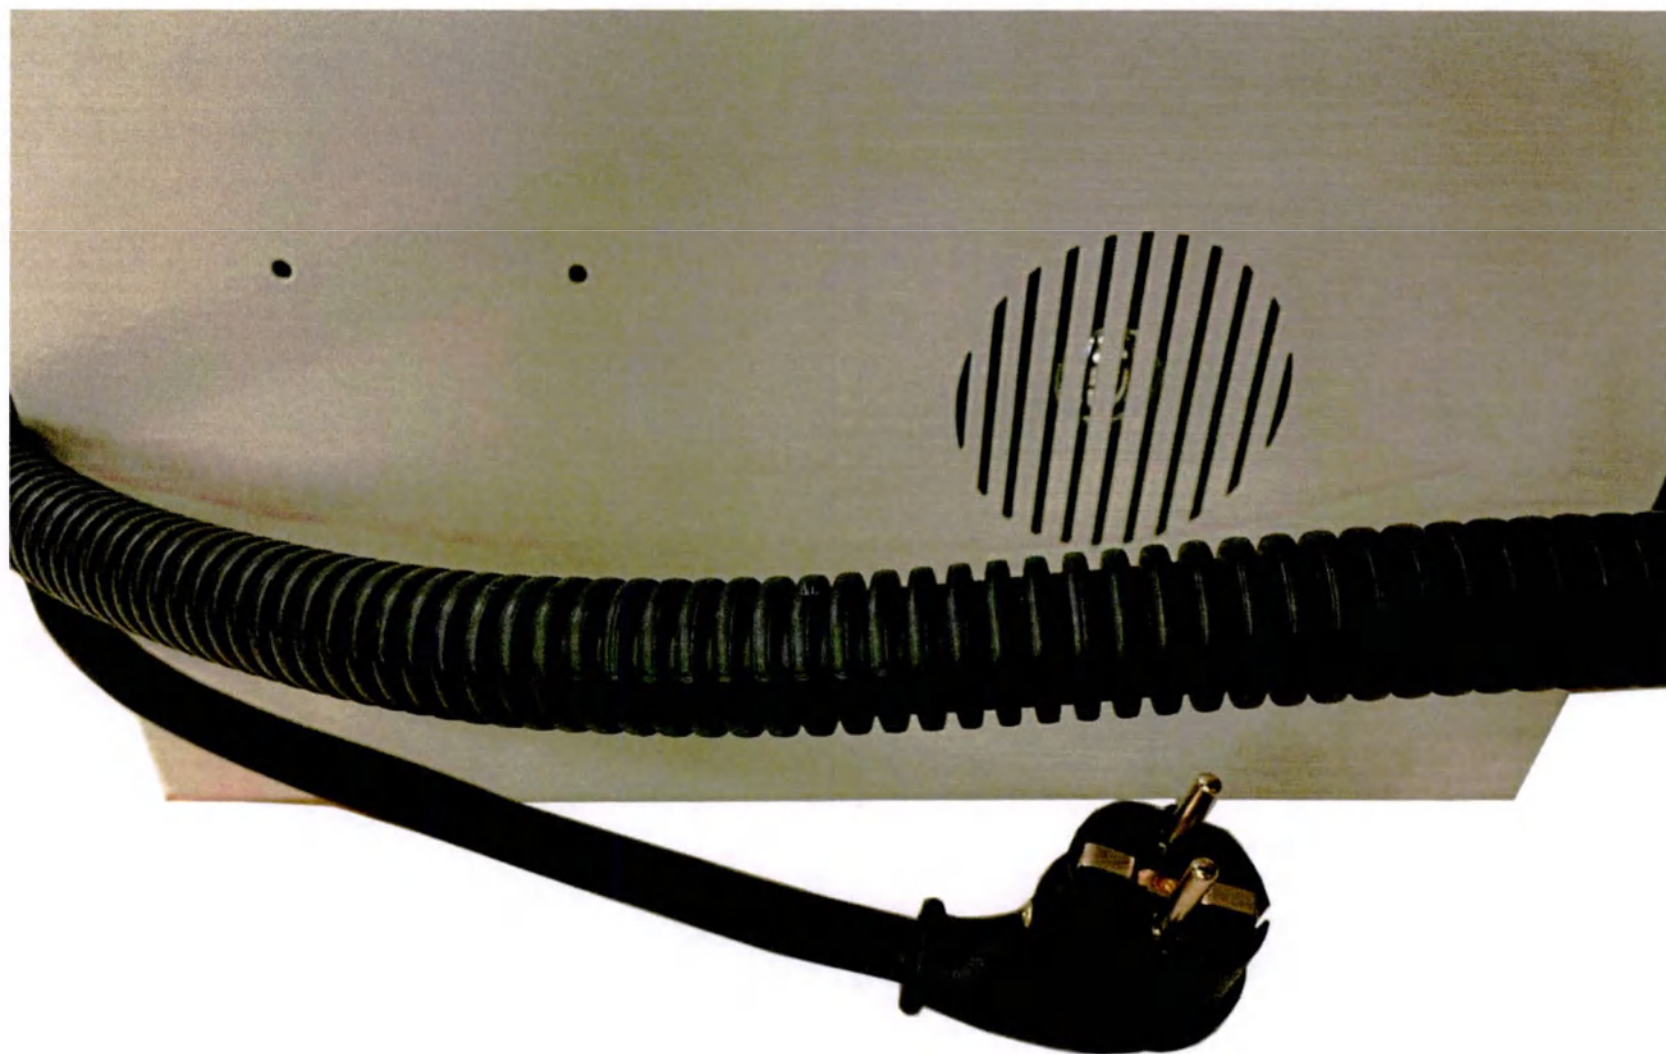

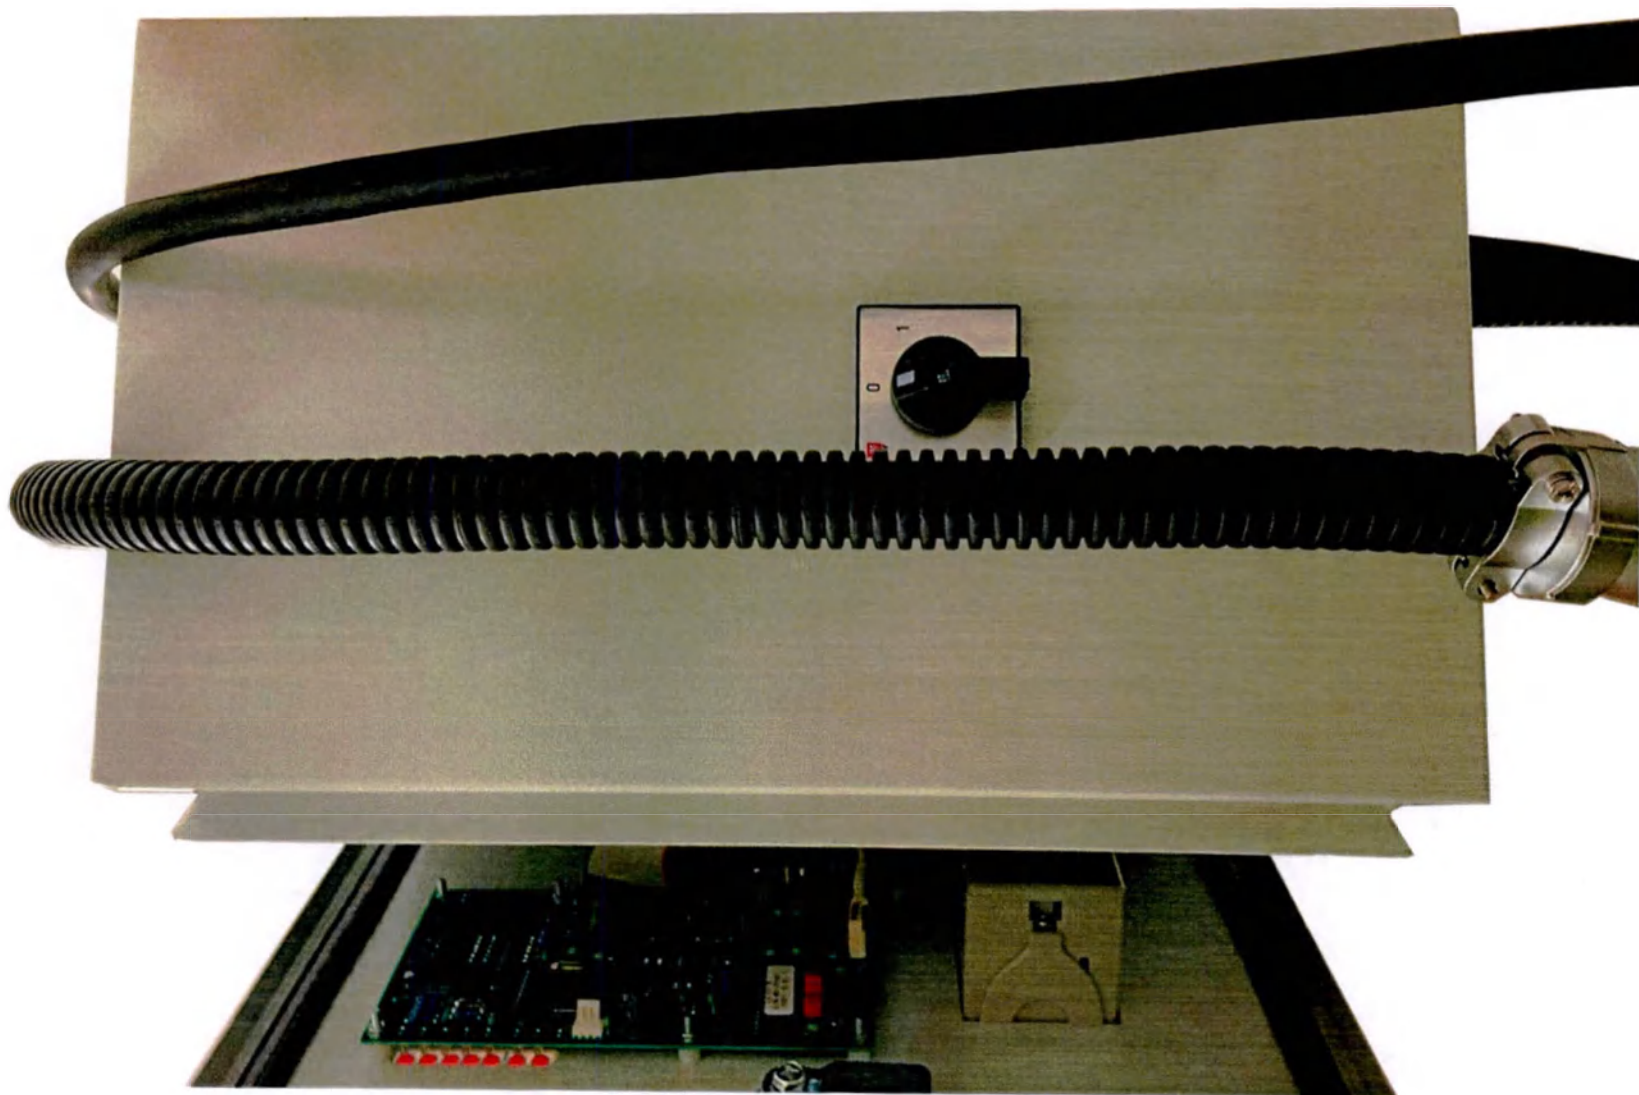


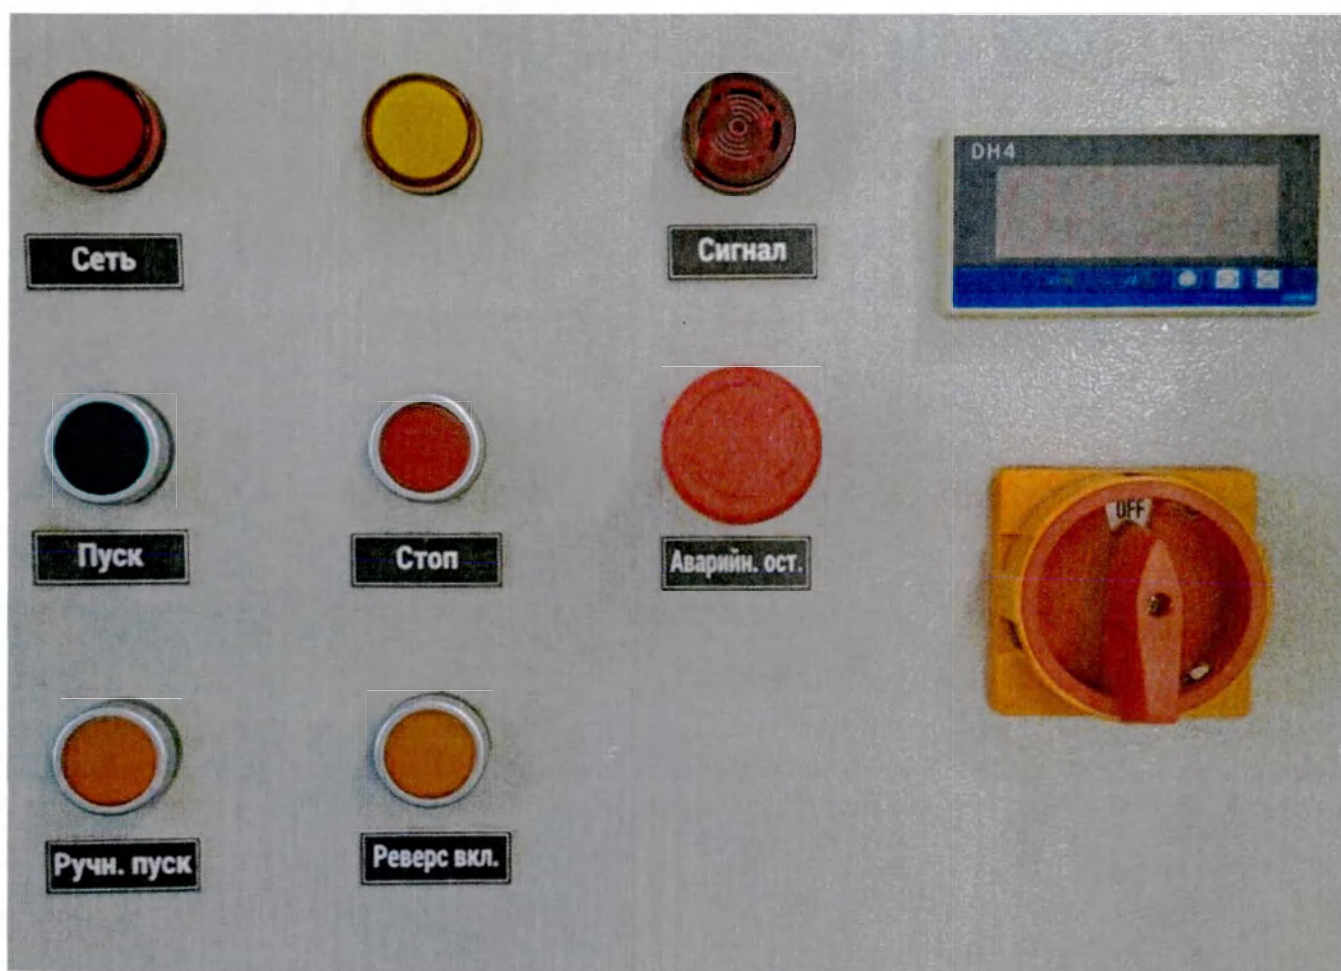

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»

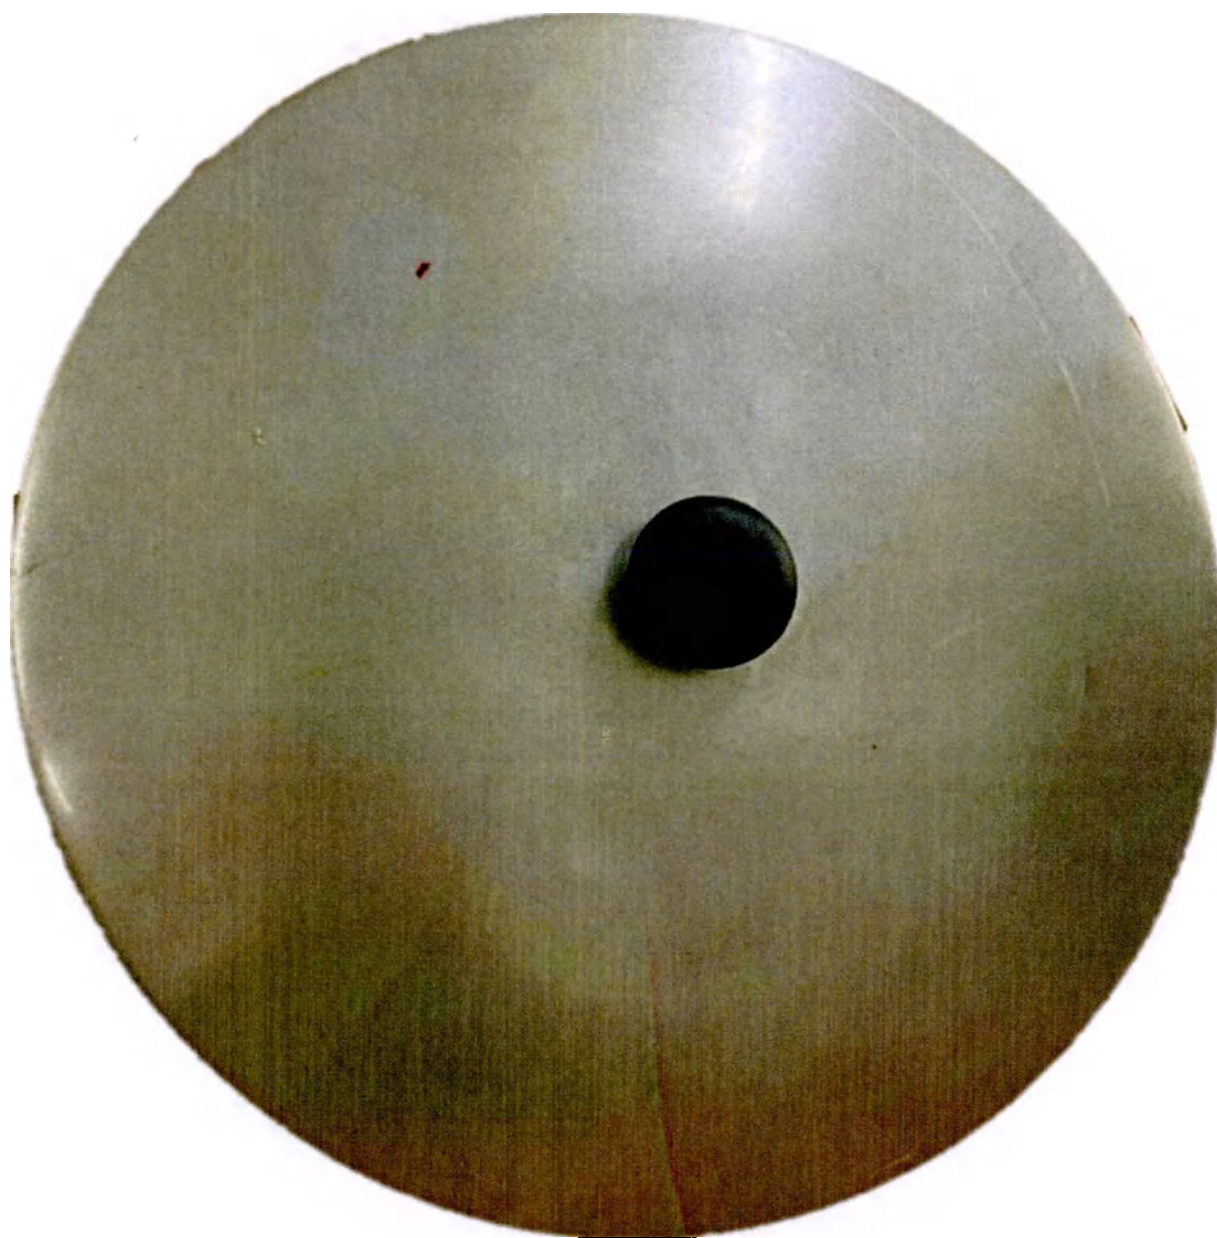

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



Трубка полимерная металлическая

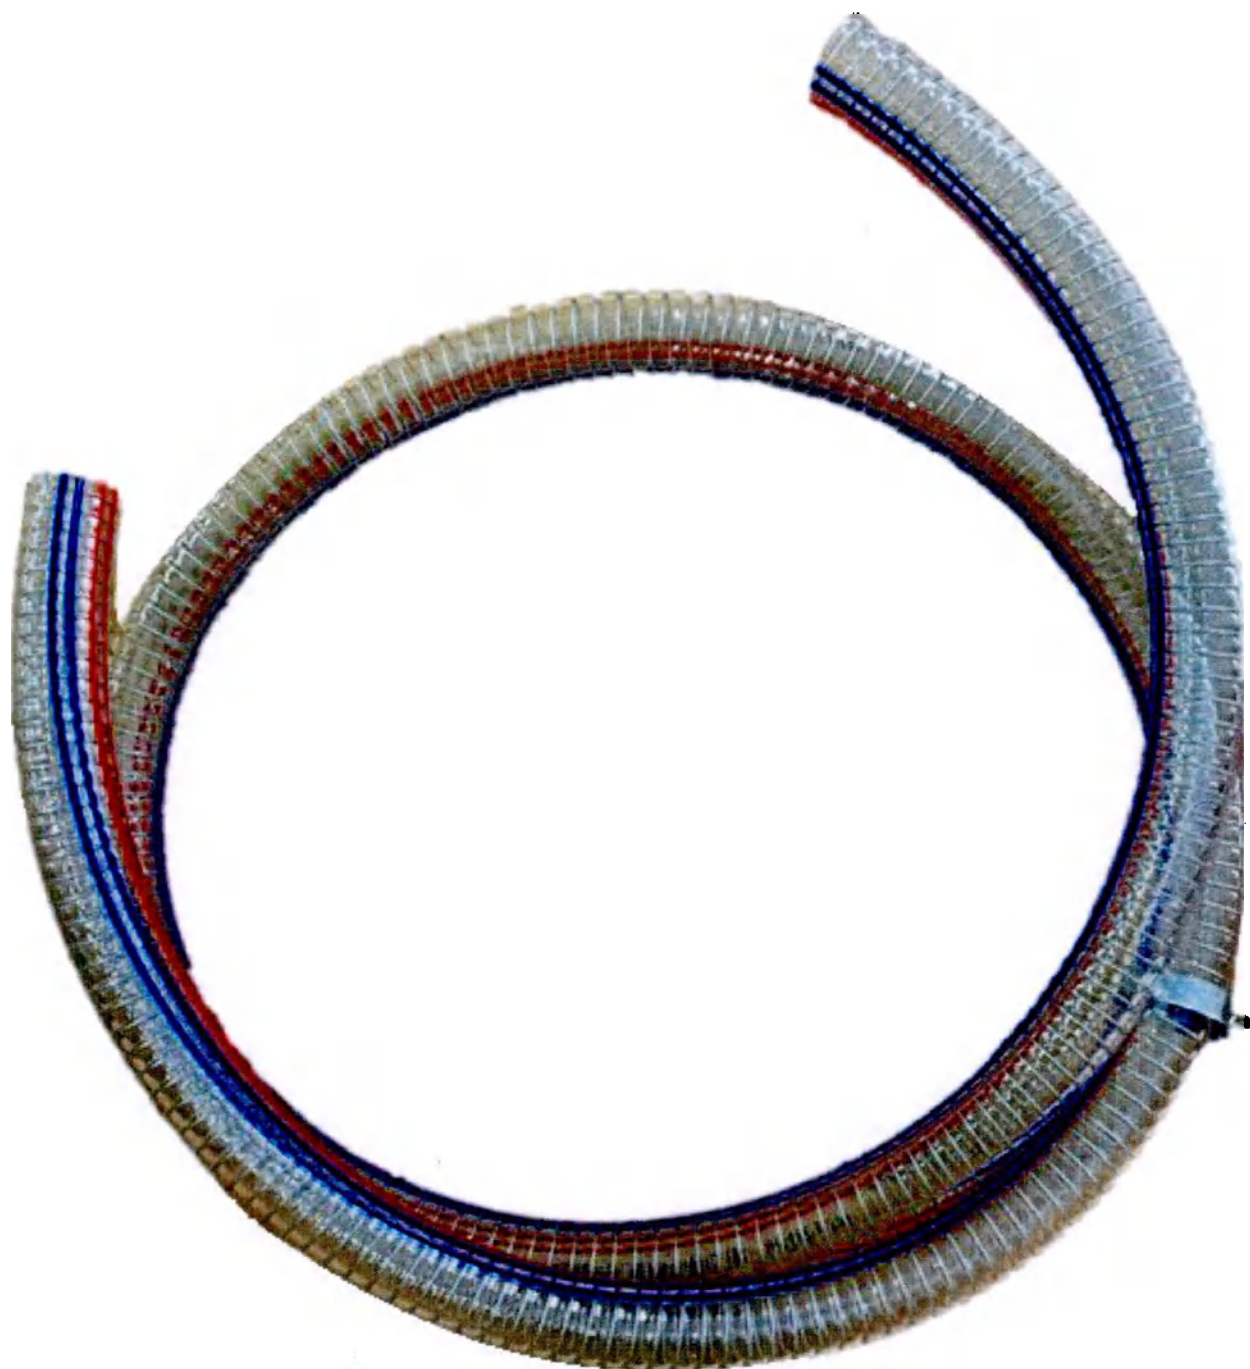

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100

**МЕДИТЕК®**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-100

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт
Объем стерилизационной камеры: 100 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

 07.2023 г.
 00118

Шредер Б модуль 2

**МЕДИТЕК®**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВт

ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

 07.2023 г.
 00118

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»

**УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ**

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш100 Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX


Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00118

10. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш200 Б»


Автоклав модуль 1-100




АВТОМАТ МОДУЛЬ 1-100

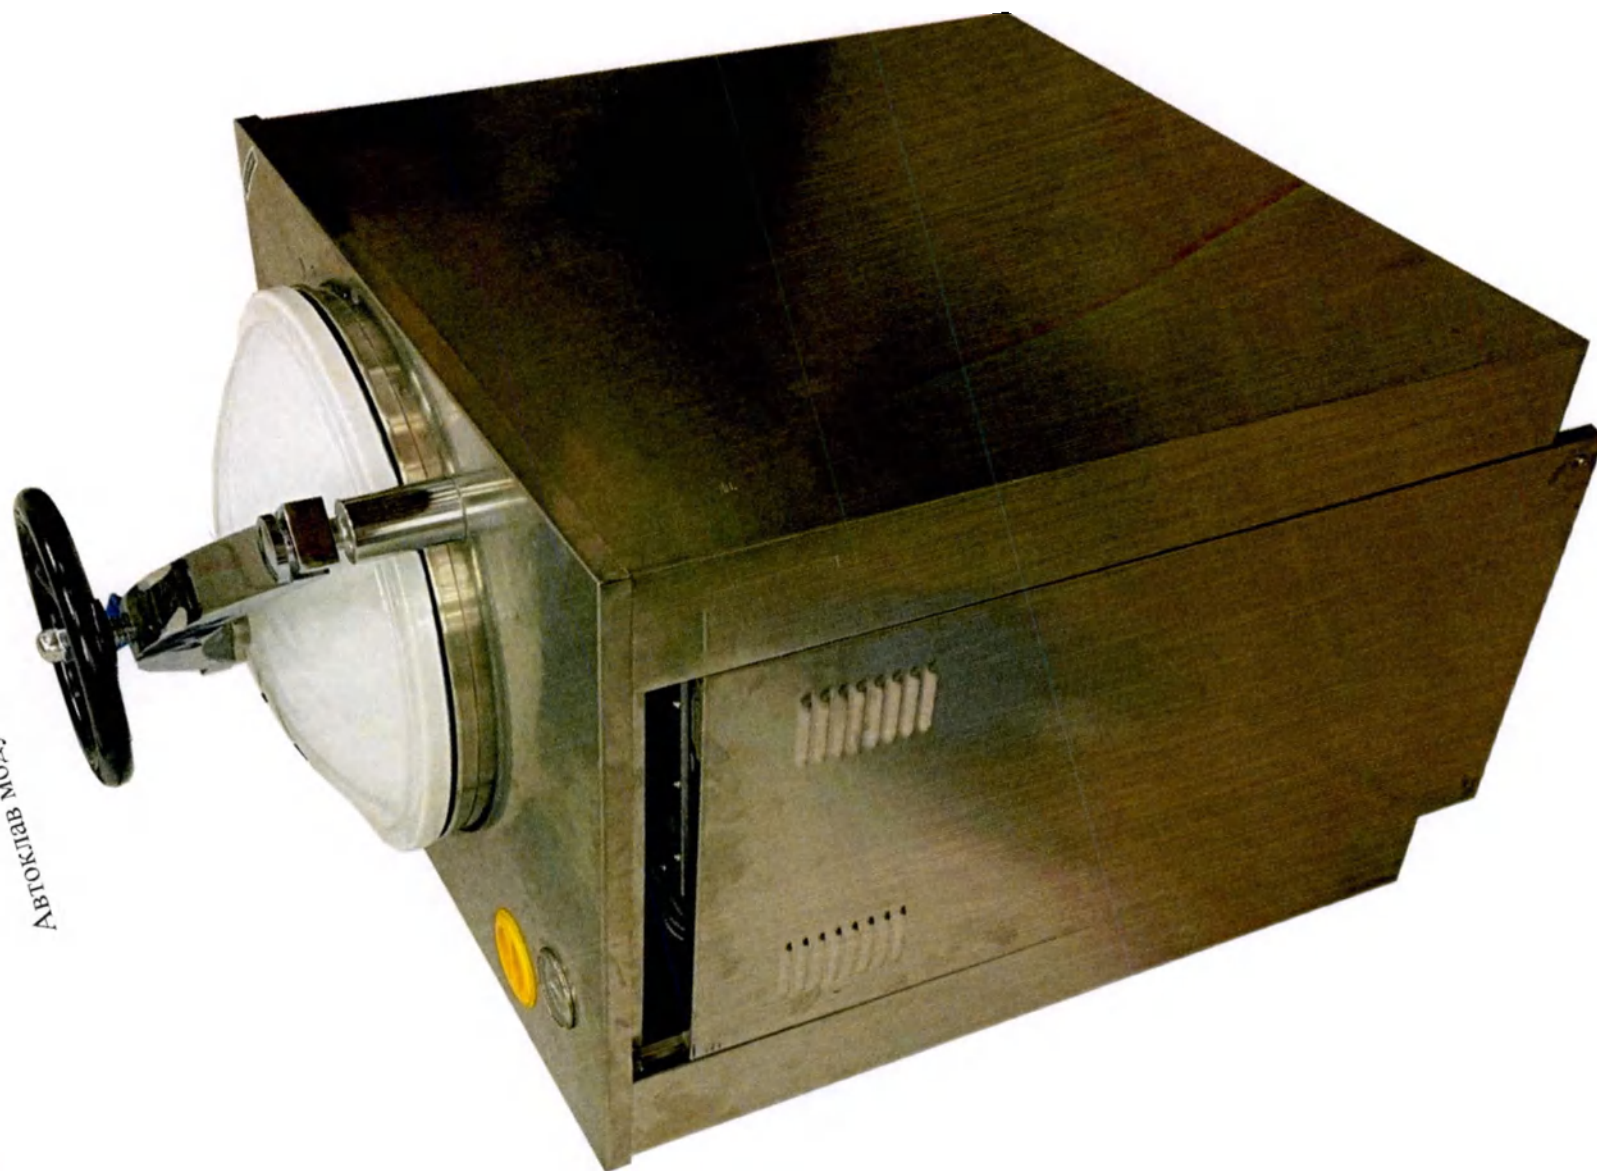



Камера автоклава модуль 1-100

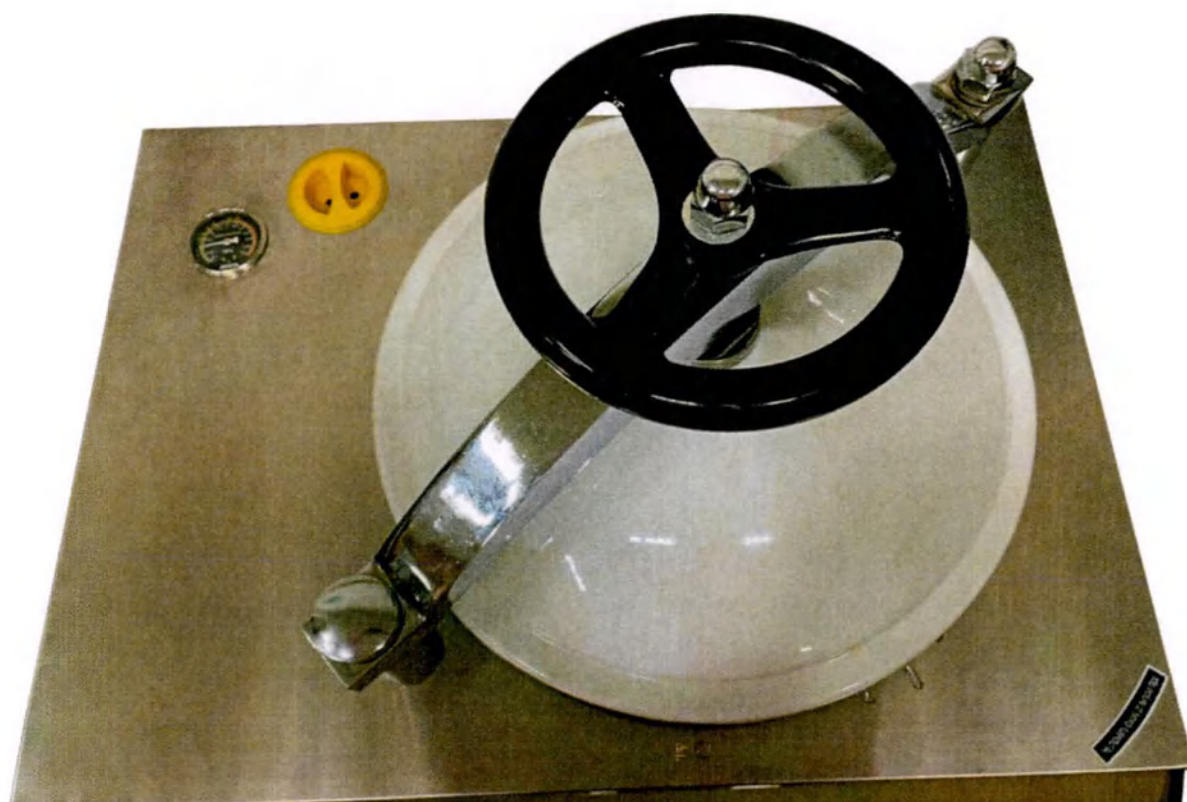


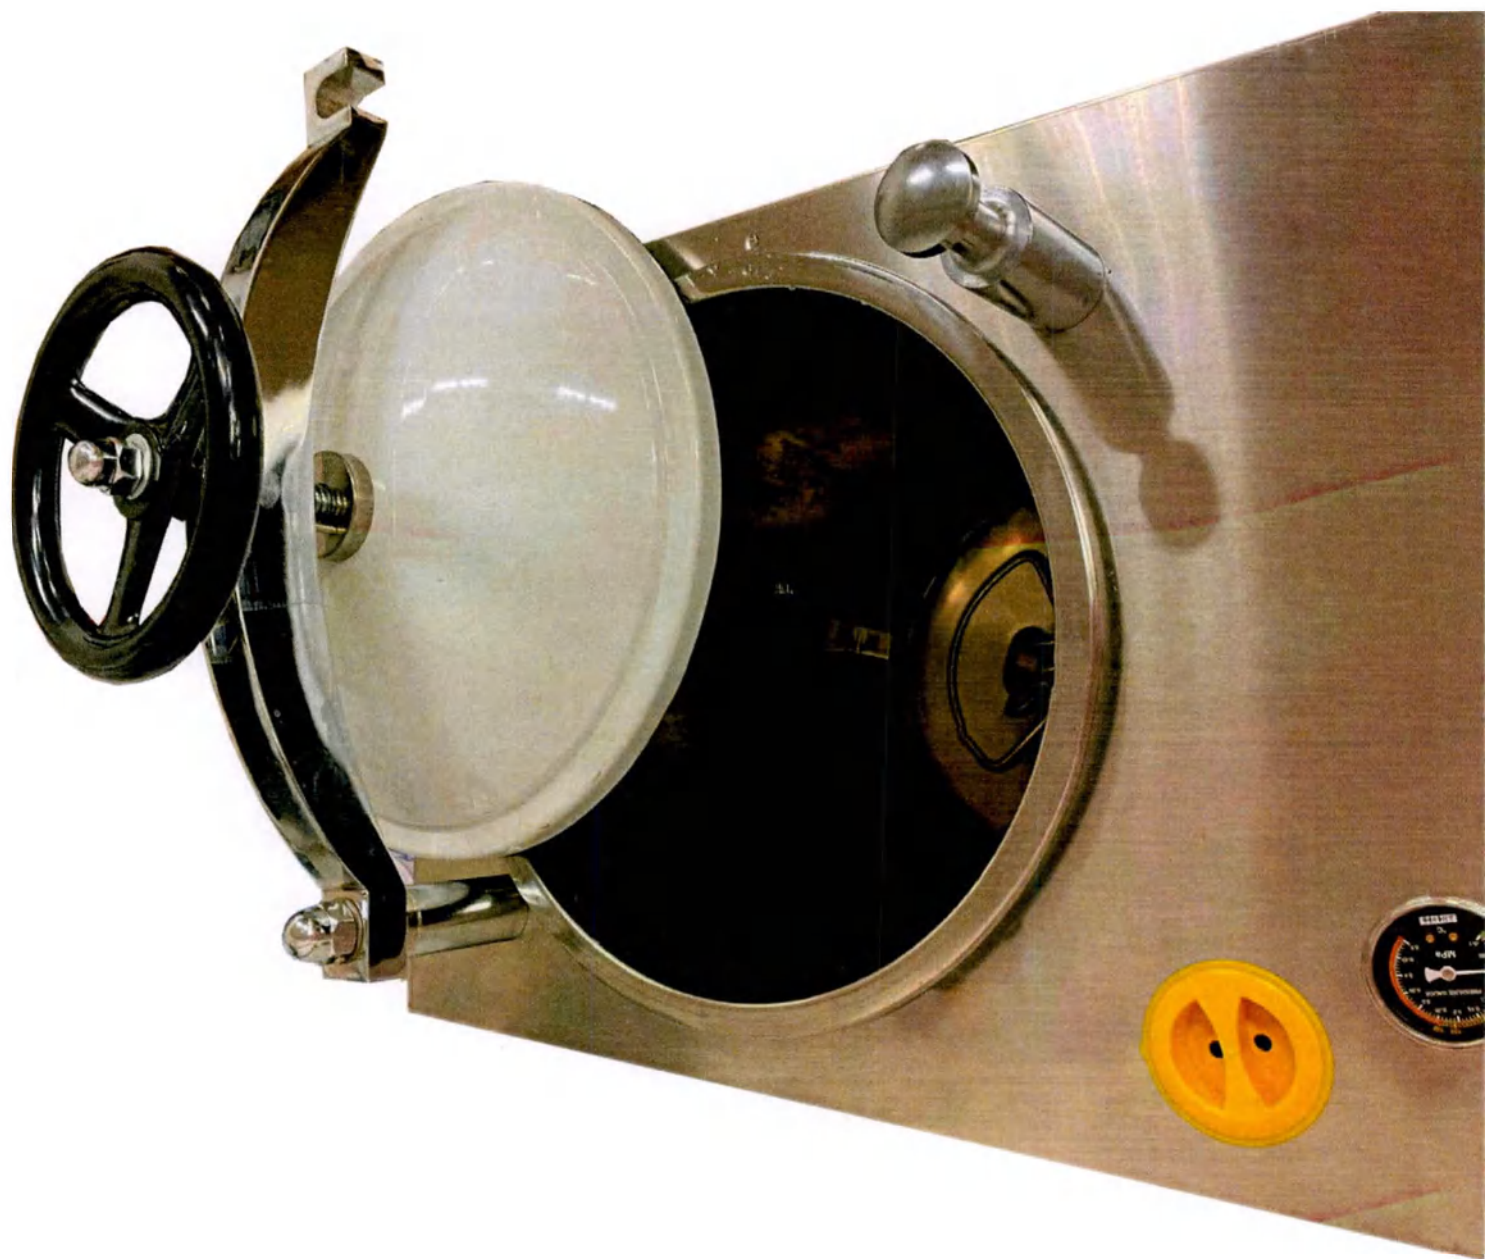





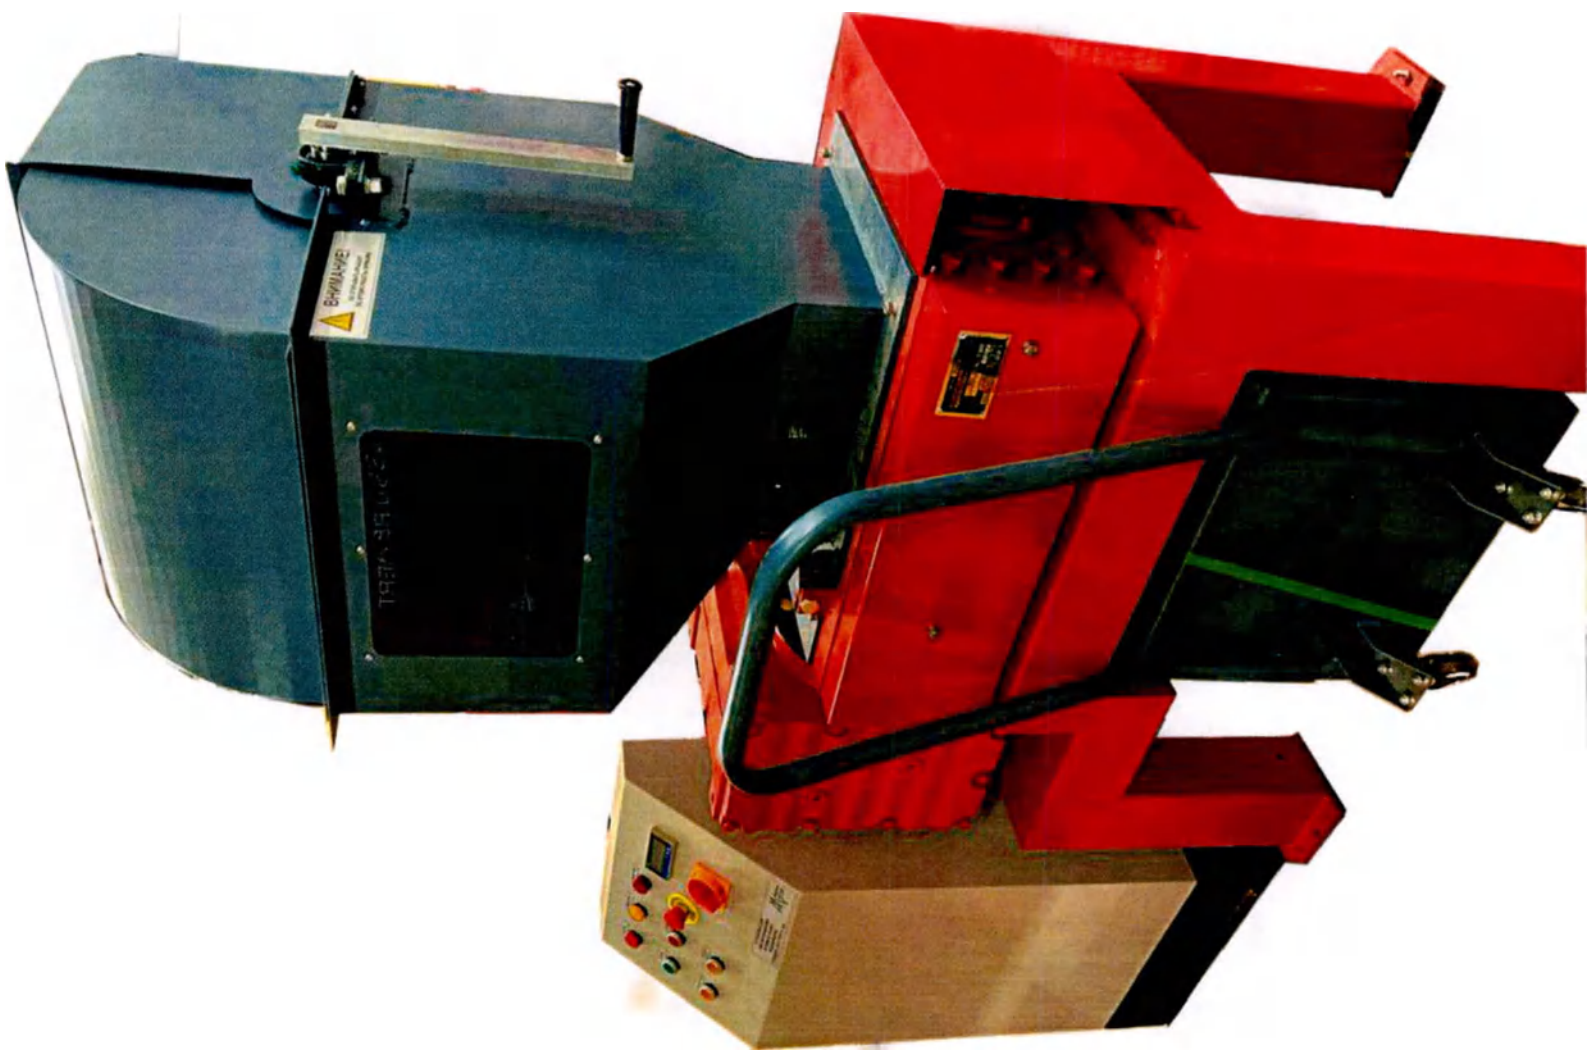


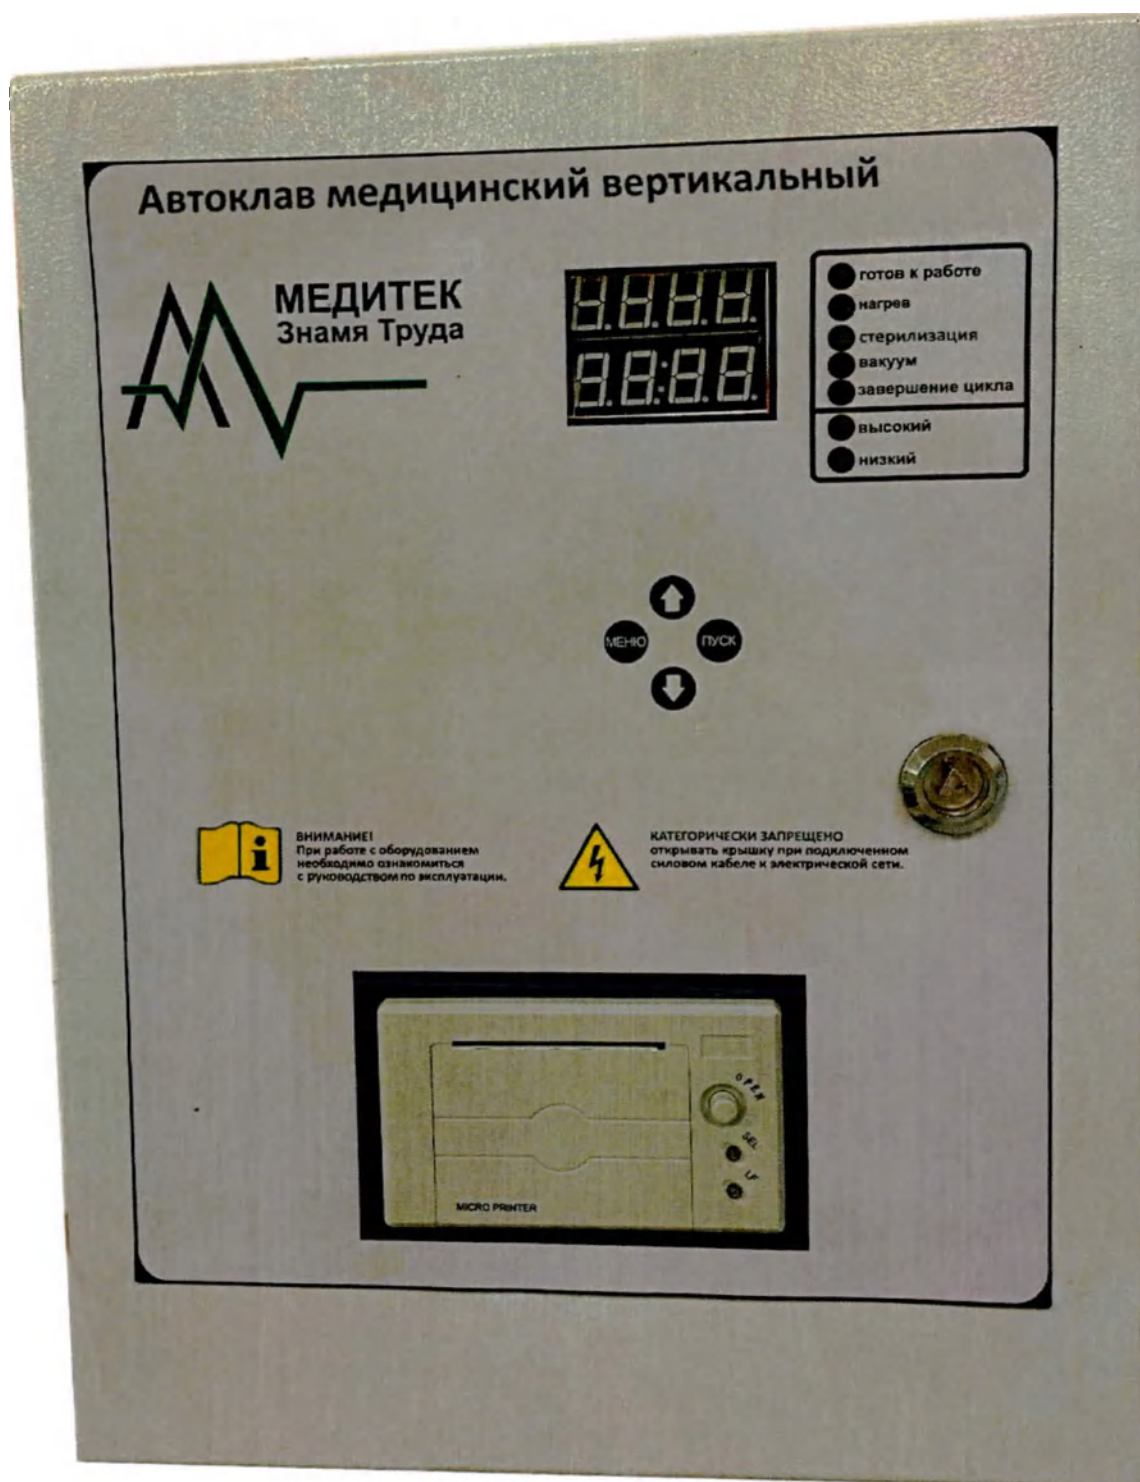

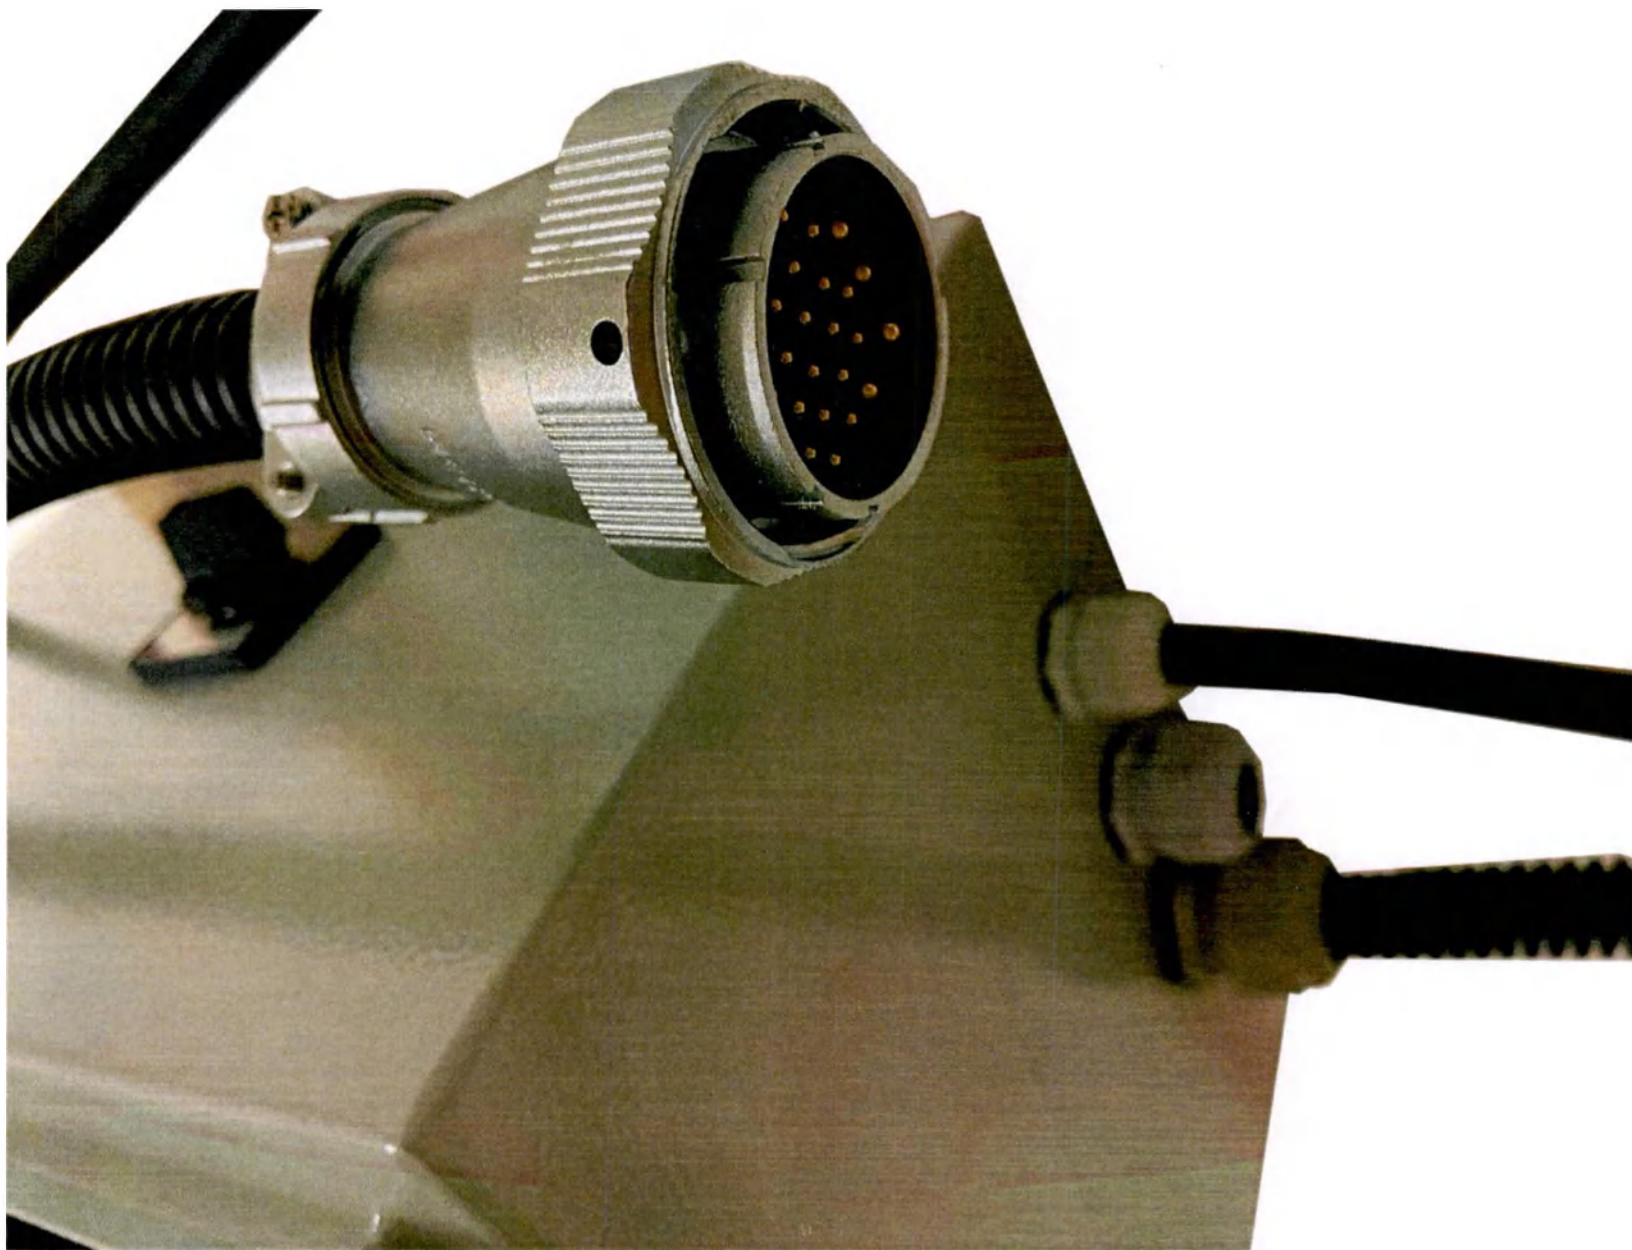

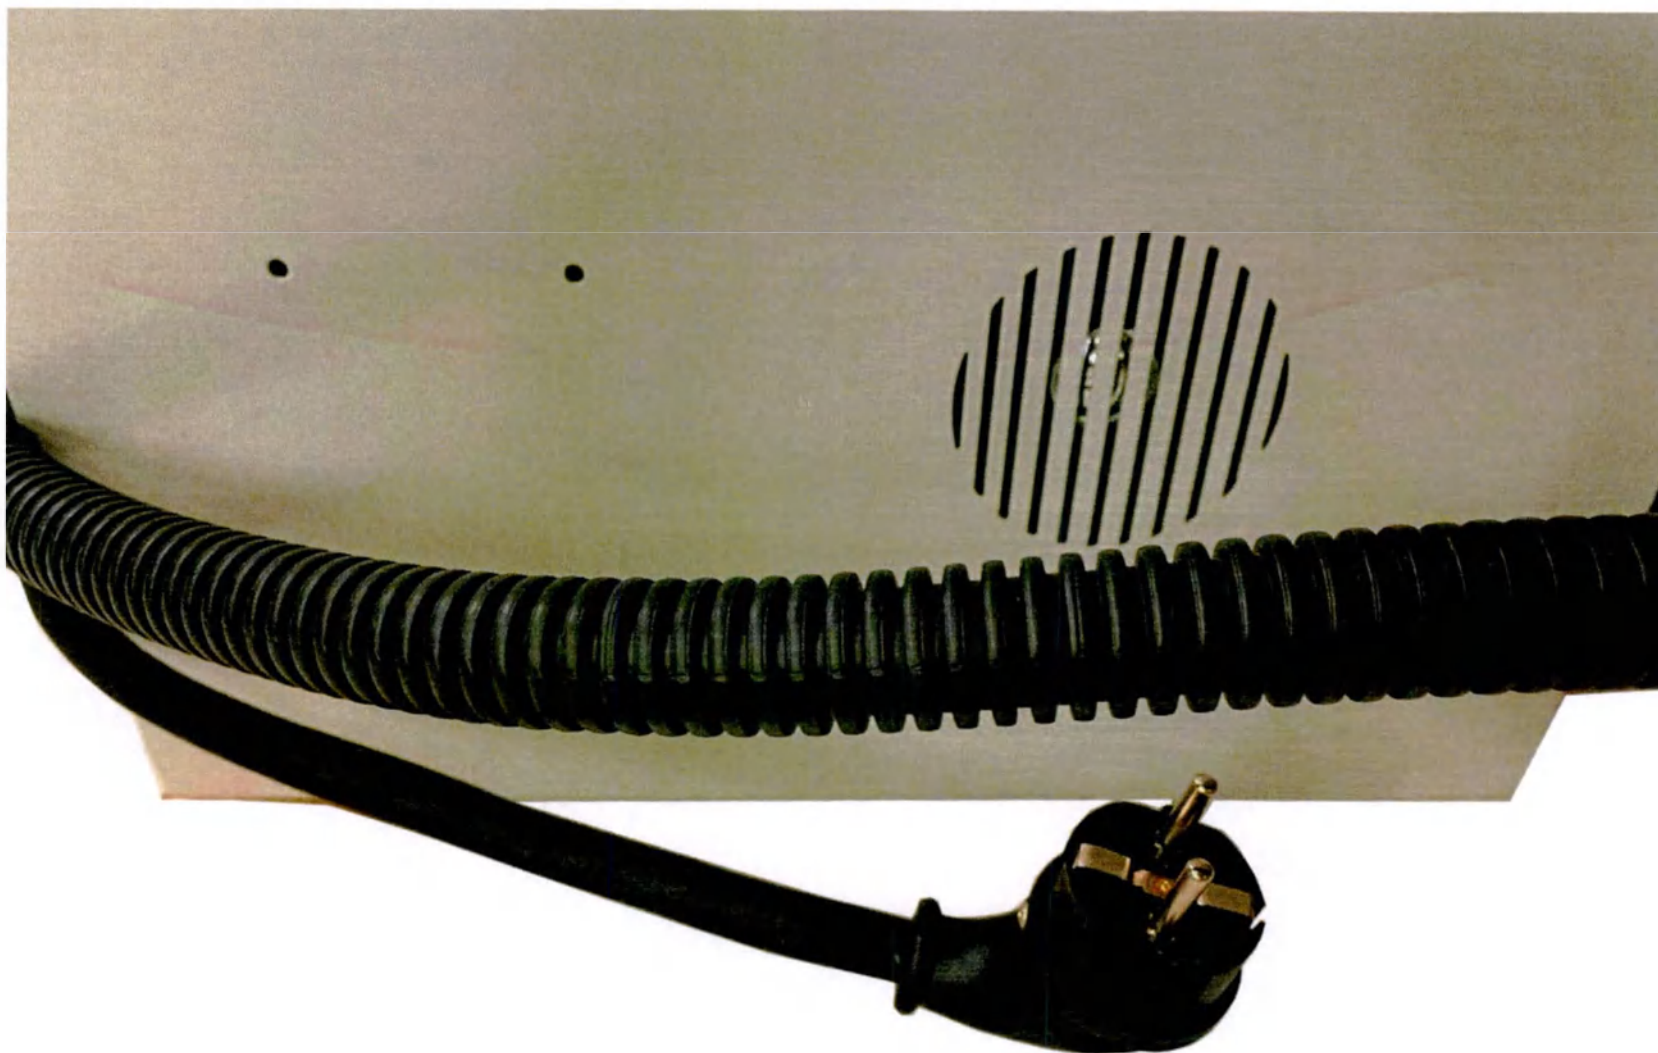

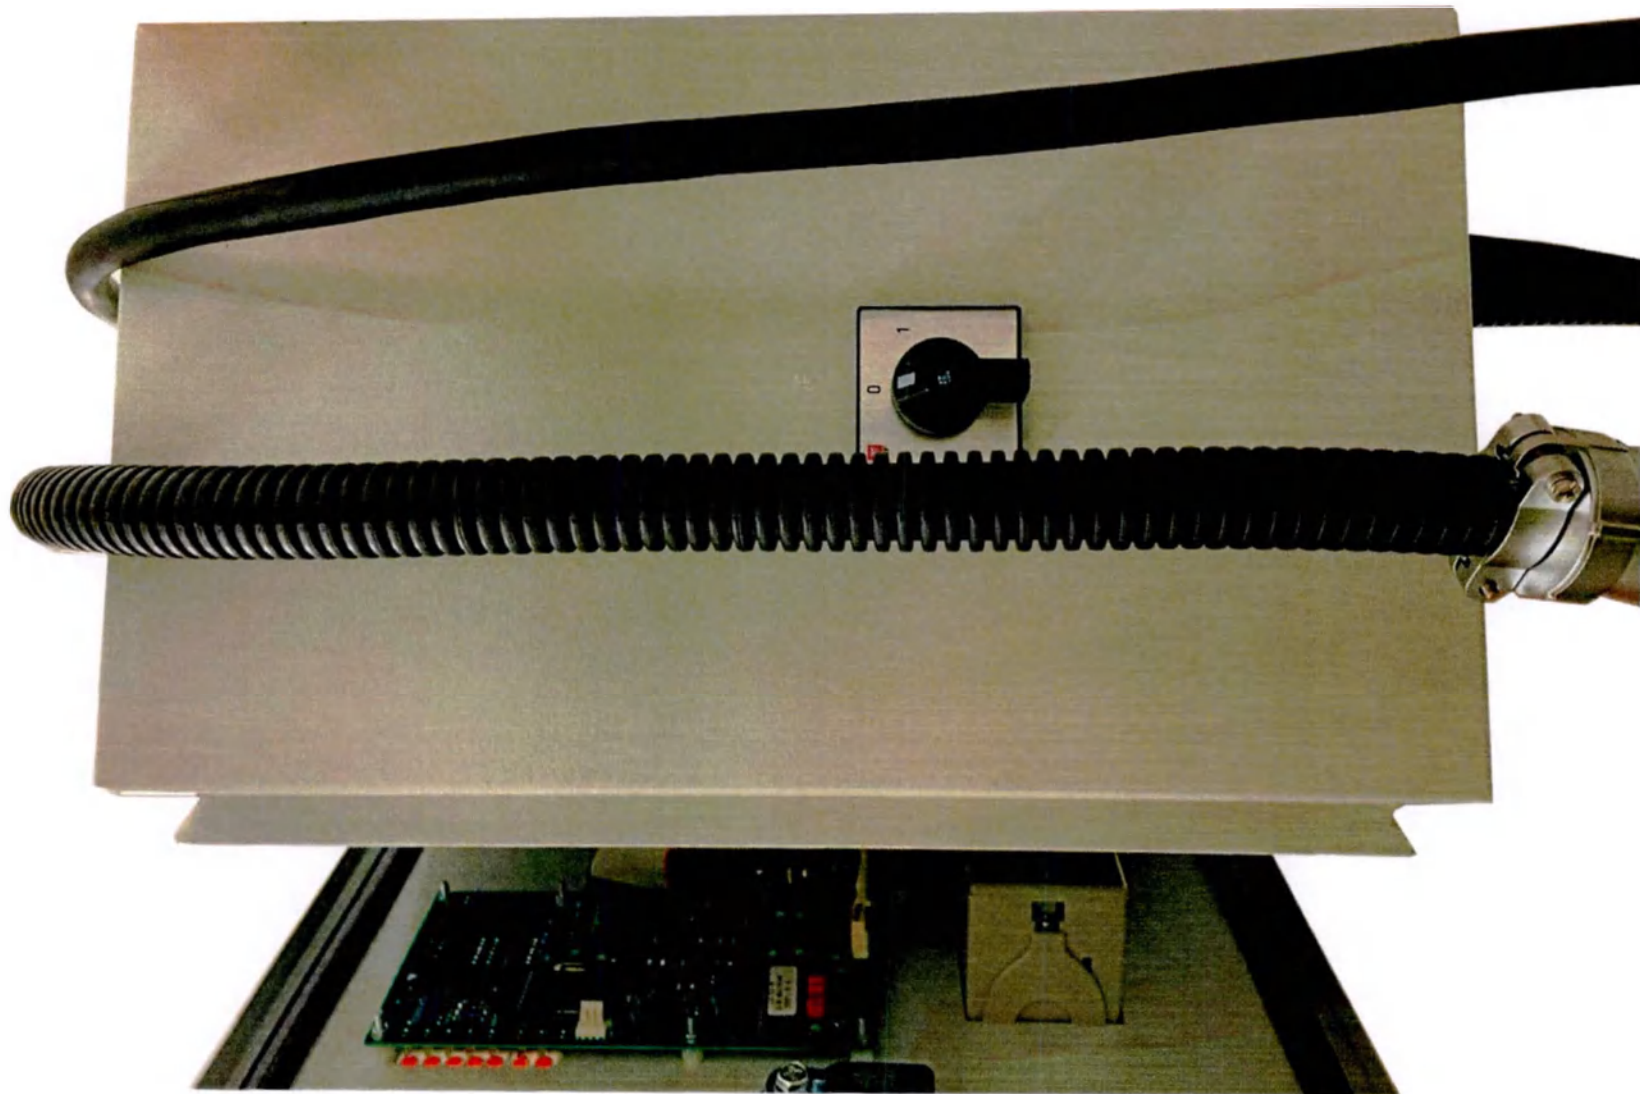


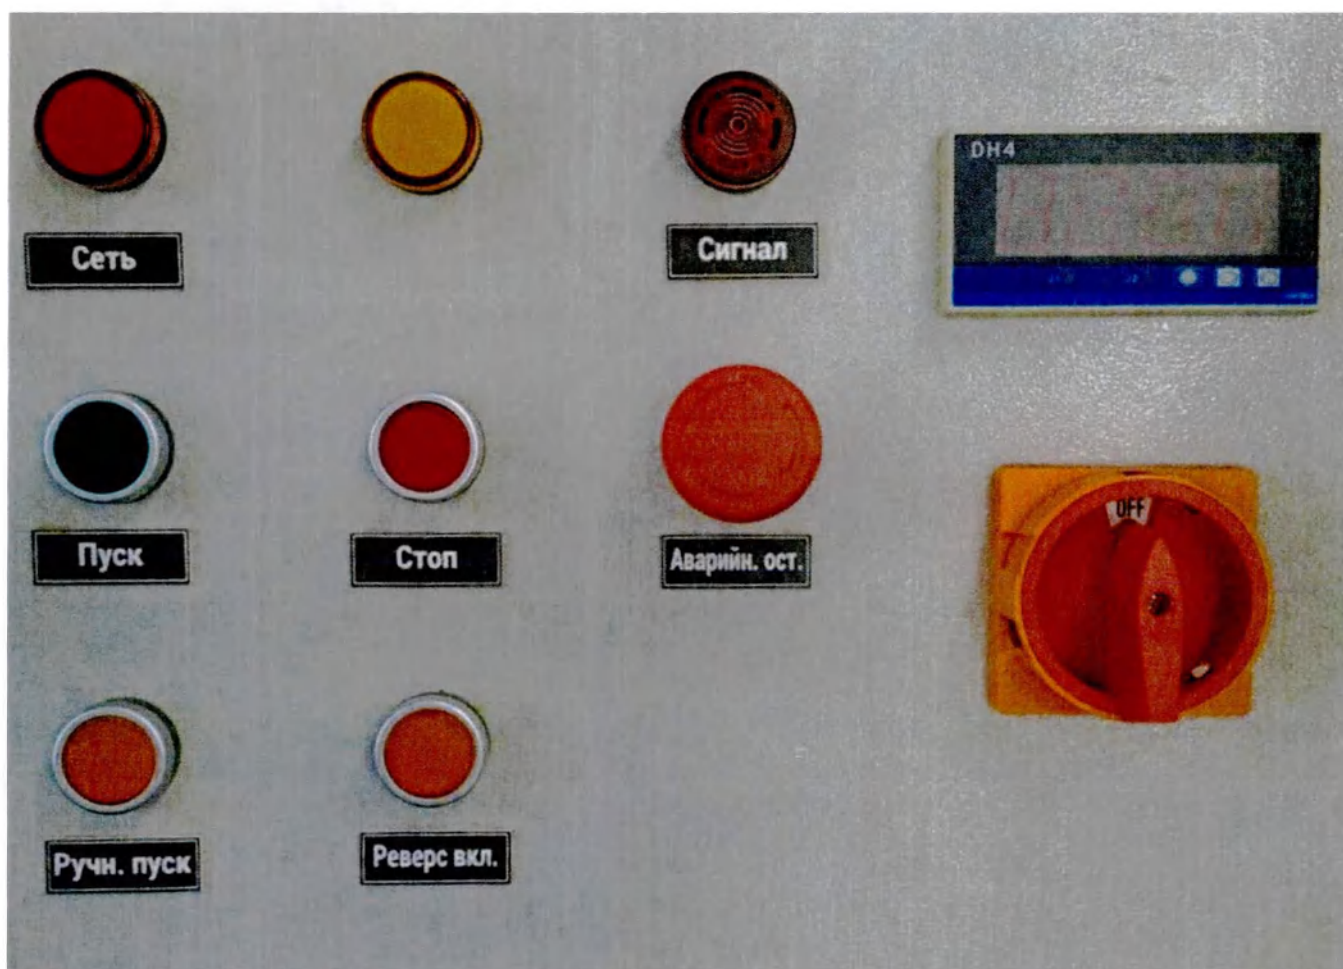


Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш200 Б»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 Б»

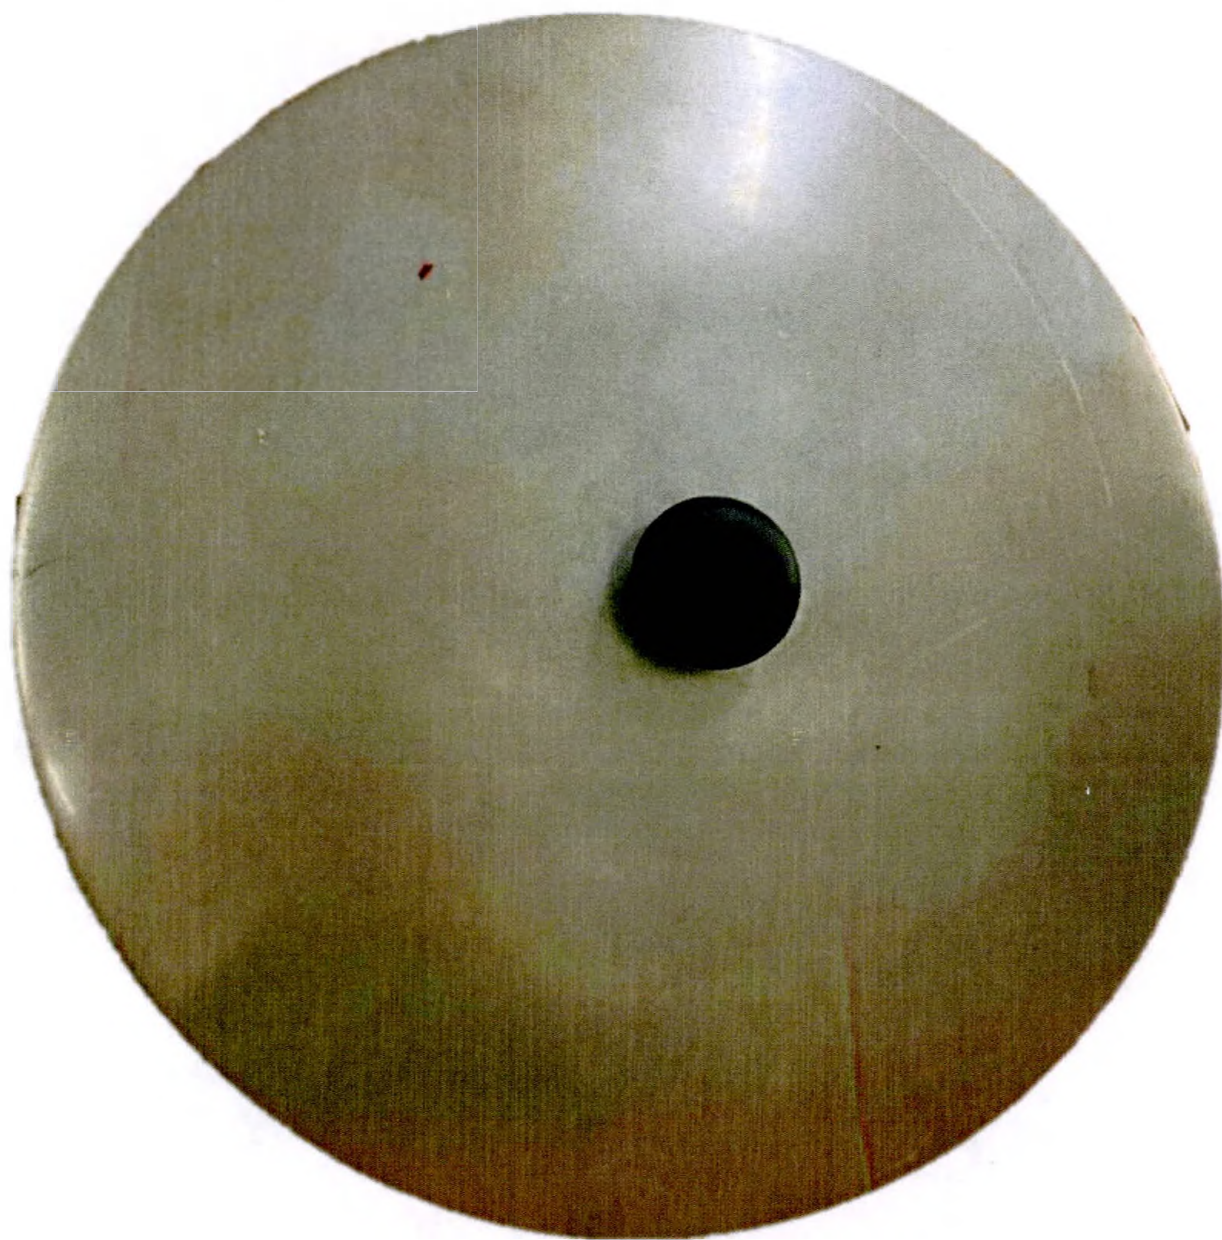

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 Б»

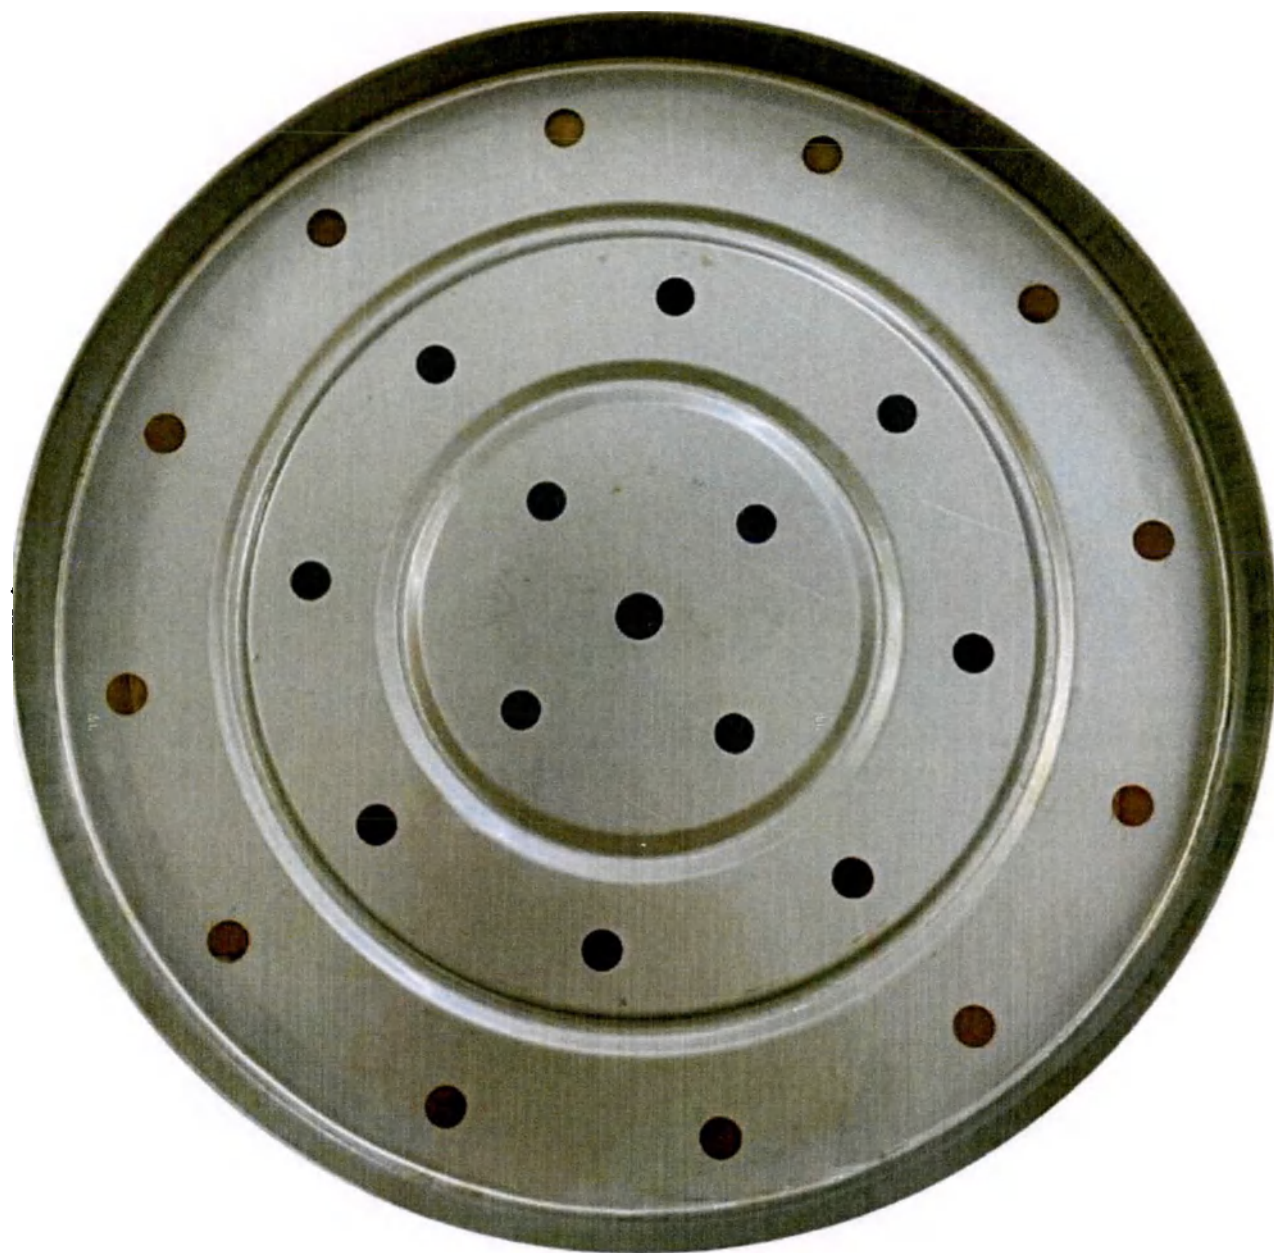


Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



Трубка полимерная металлическая

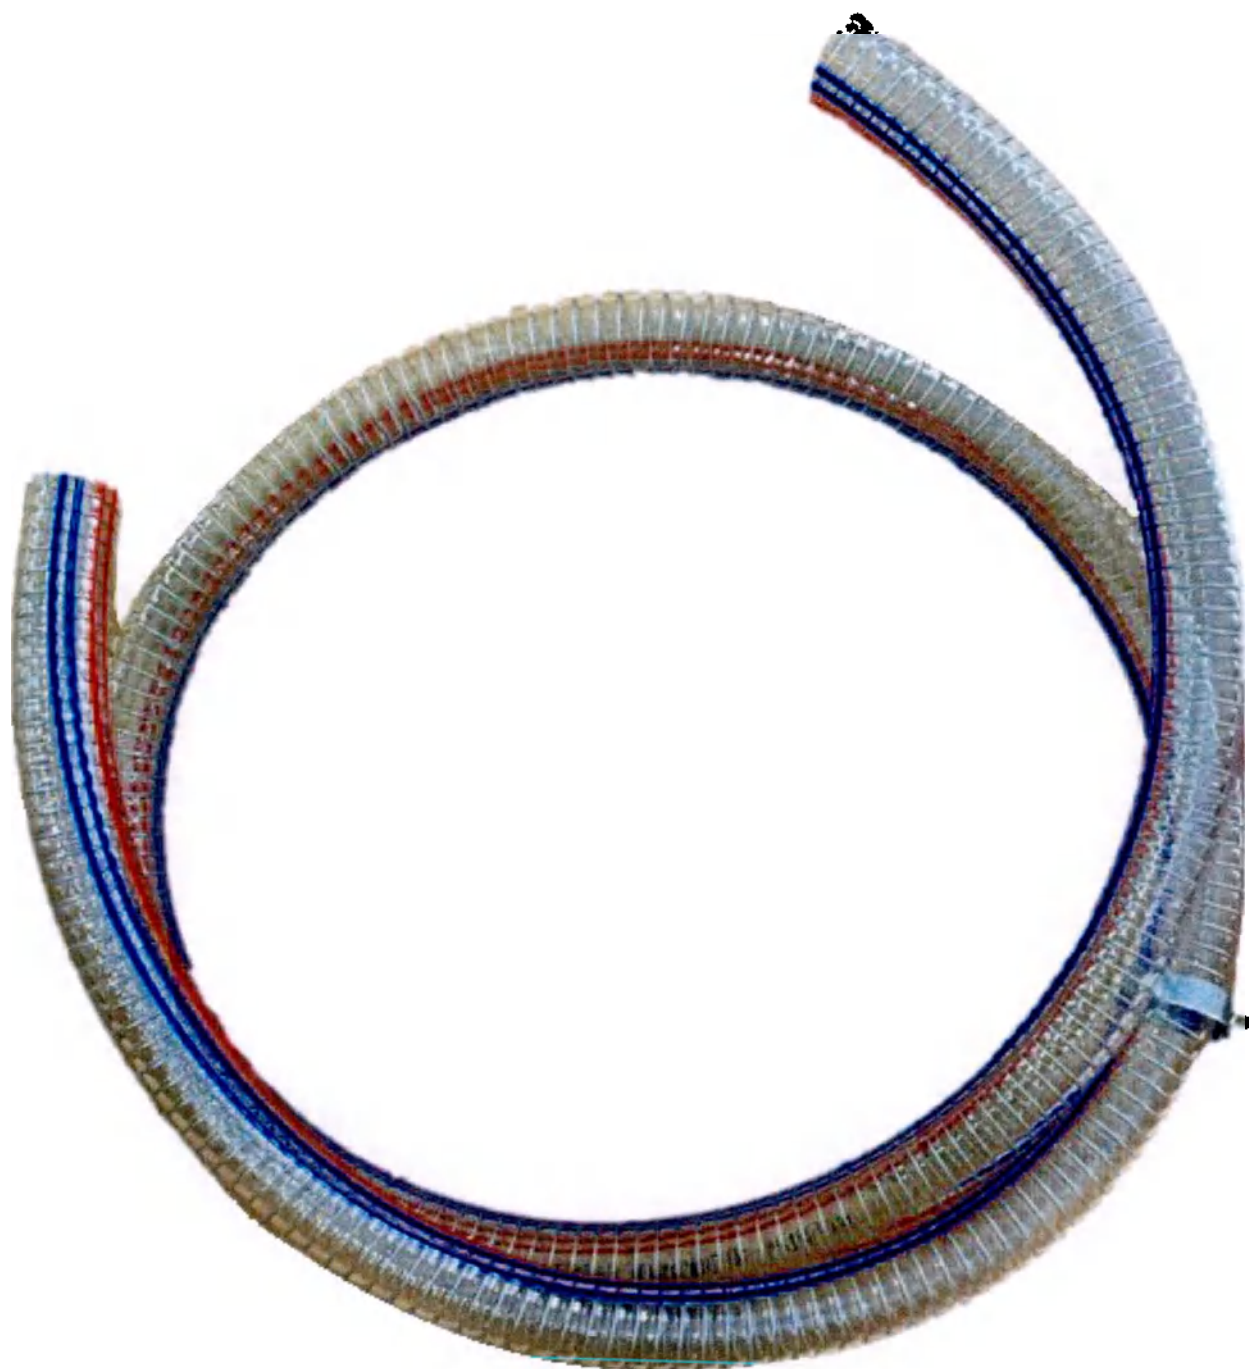

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100

 **МЕДИТЕК**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-100

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВА
Объем стерилизационной камеры: 100 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 SN 00119/1

 РУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Маркировка Автоклав модуль 1-100

 **МЕДИТЕК**
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-100

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВА
Объем стерилизационной камеры: 100 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 SN 00119/2

 РУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Маркировка Шредер Б модуль 2



Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш200 Б»




11. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш300 Б»

Автоклав модуль 1-100



Автоматический мойщик 1-100

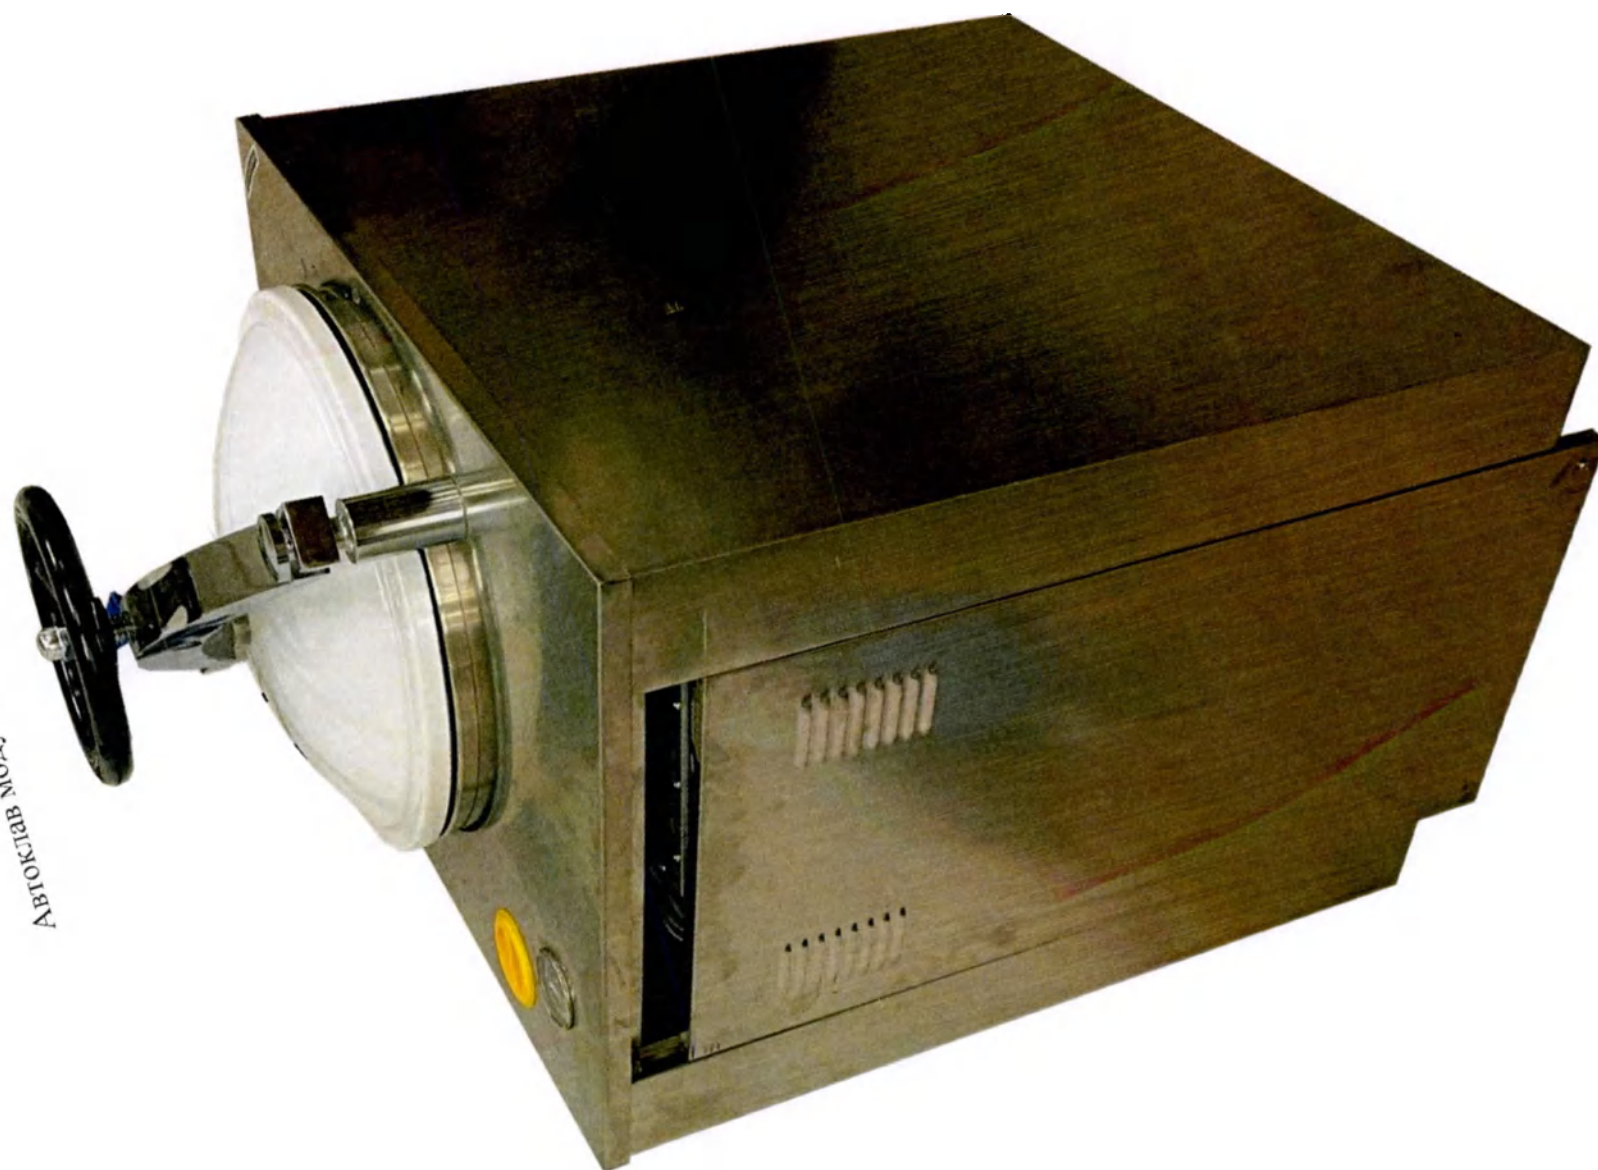


001

Автоклав модуль 1-100





Камера автоклава модуль 1-100



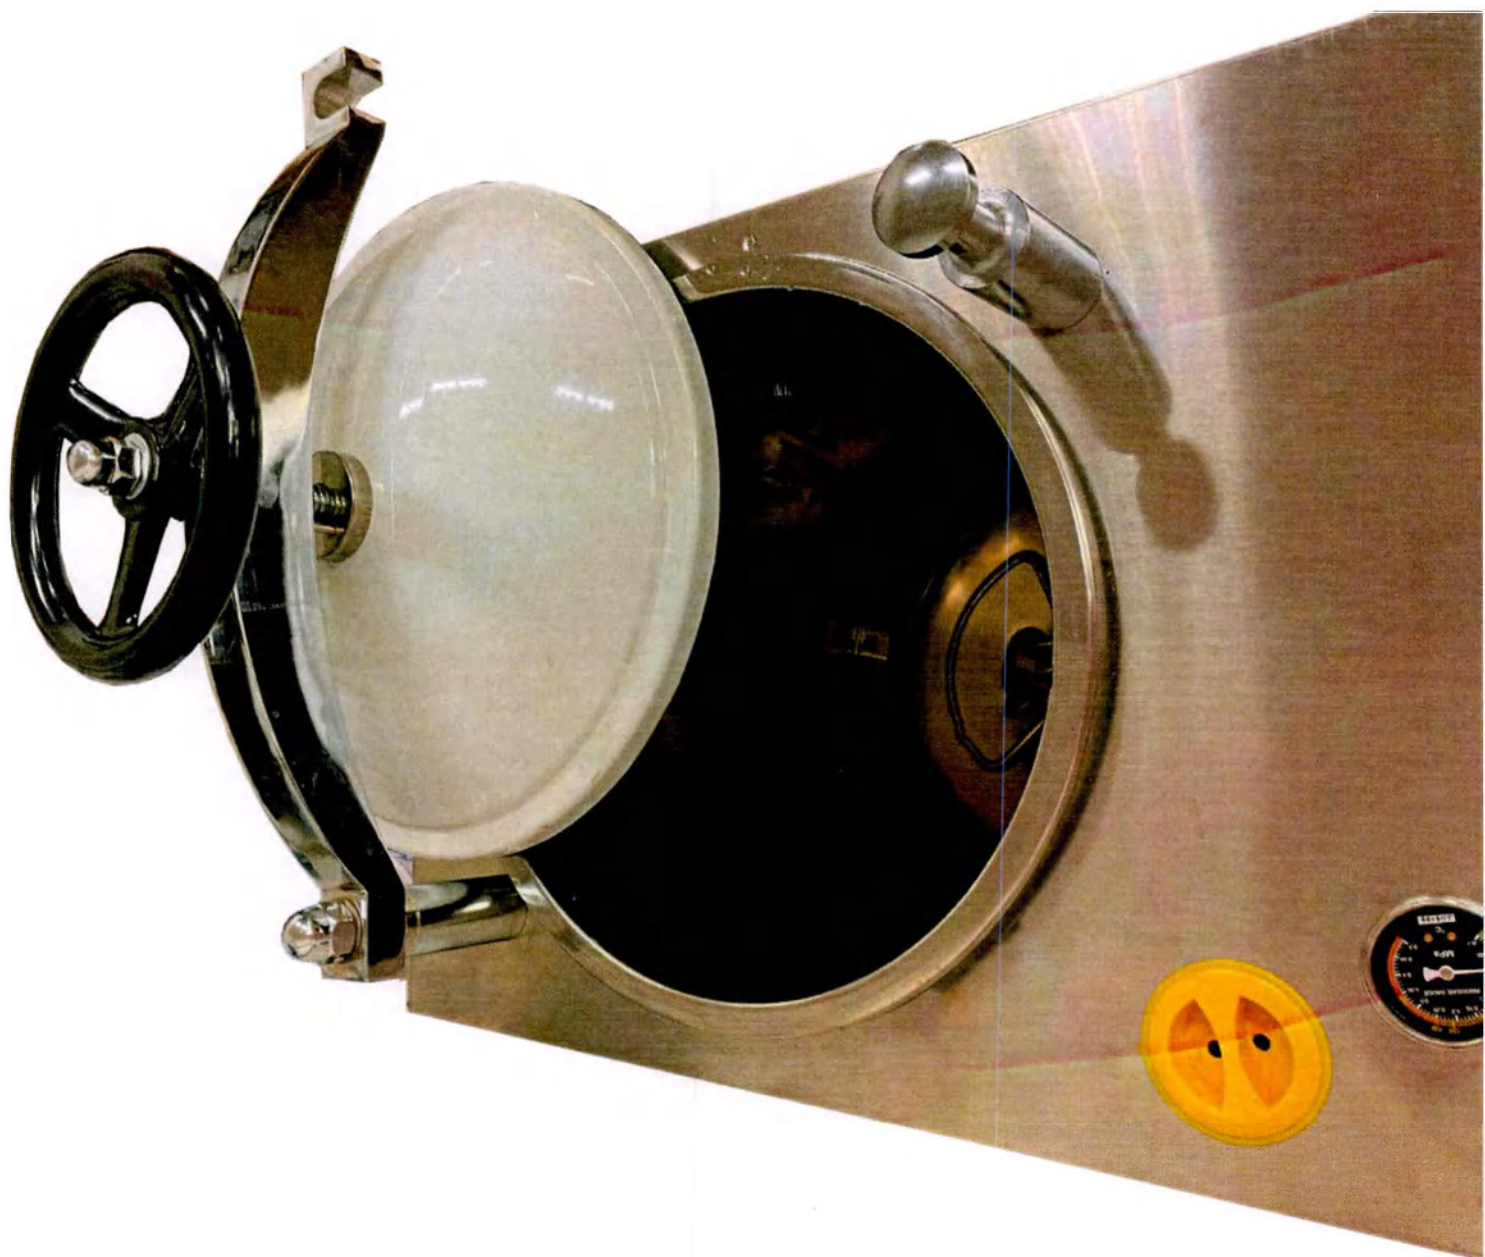





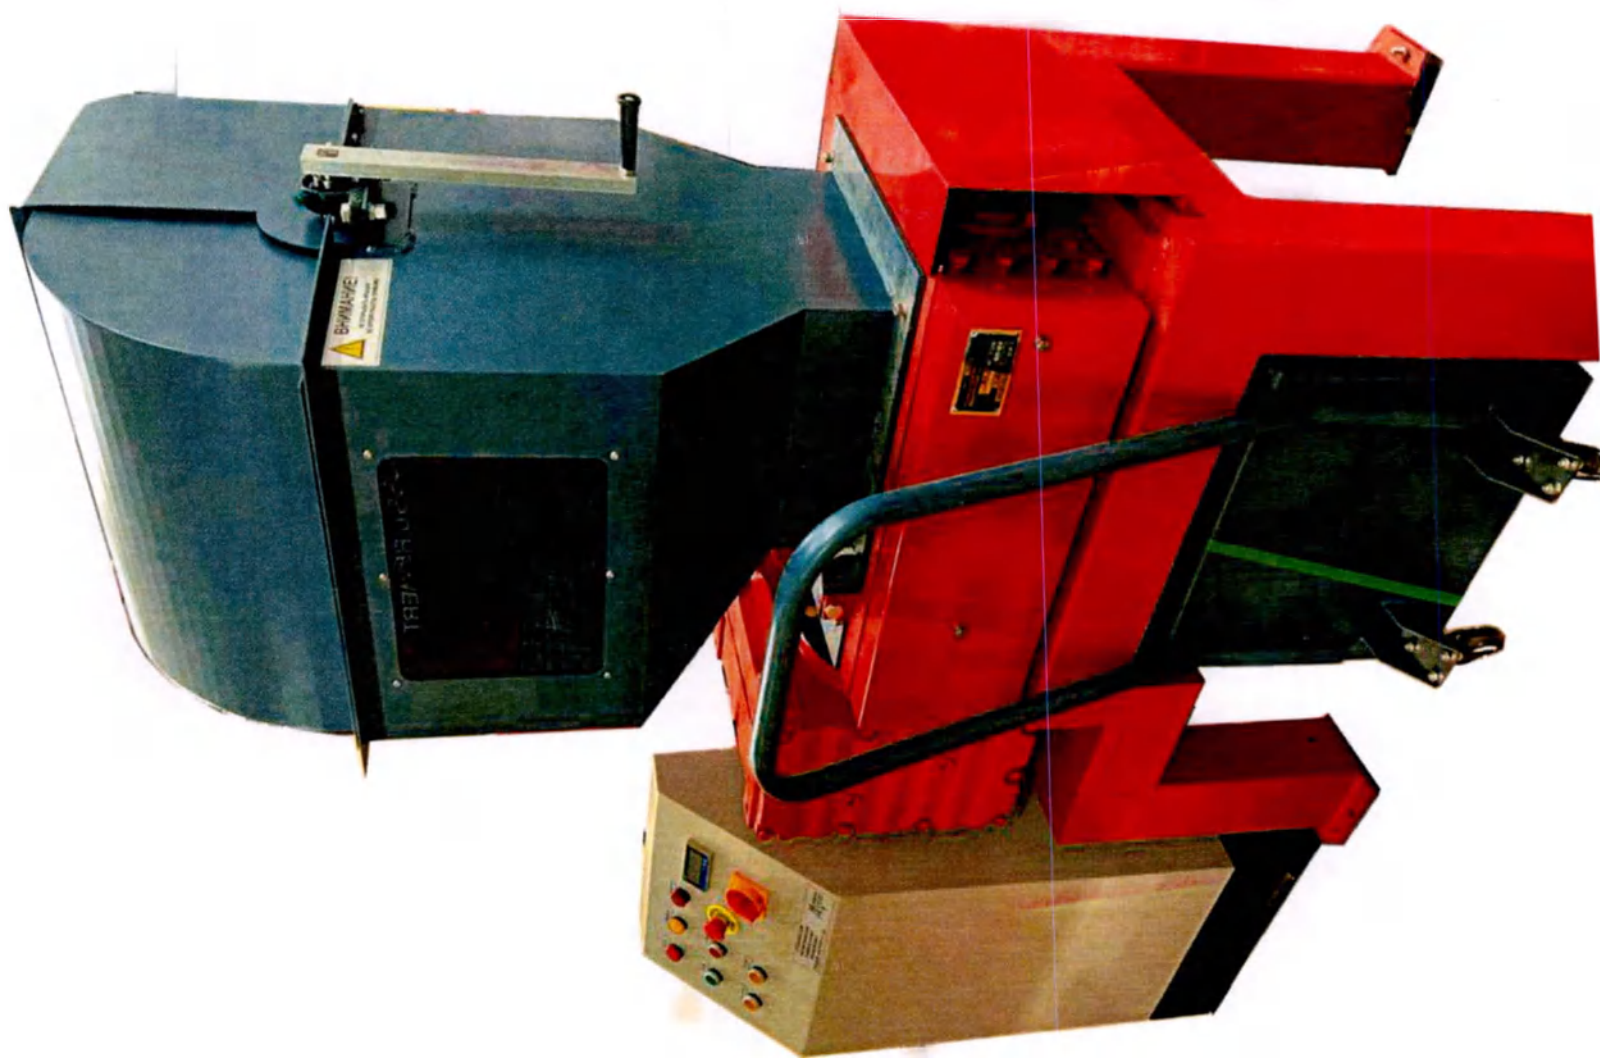

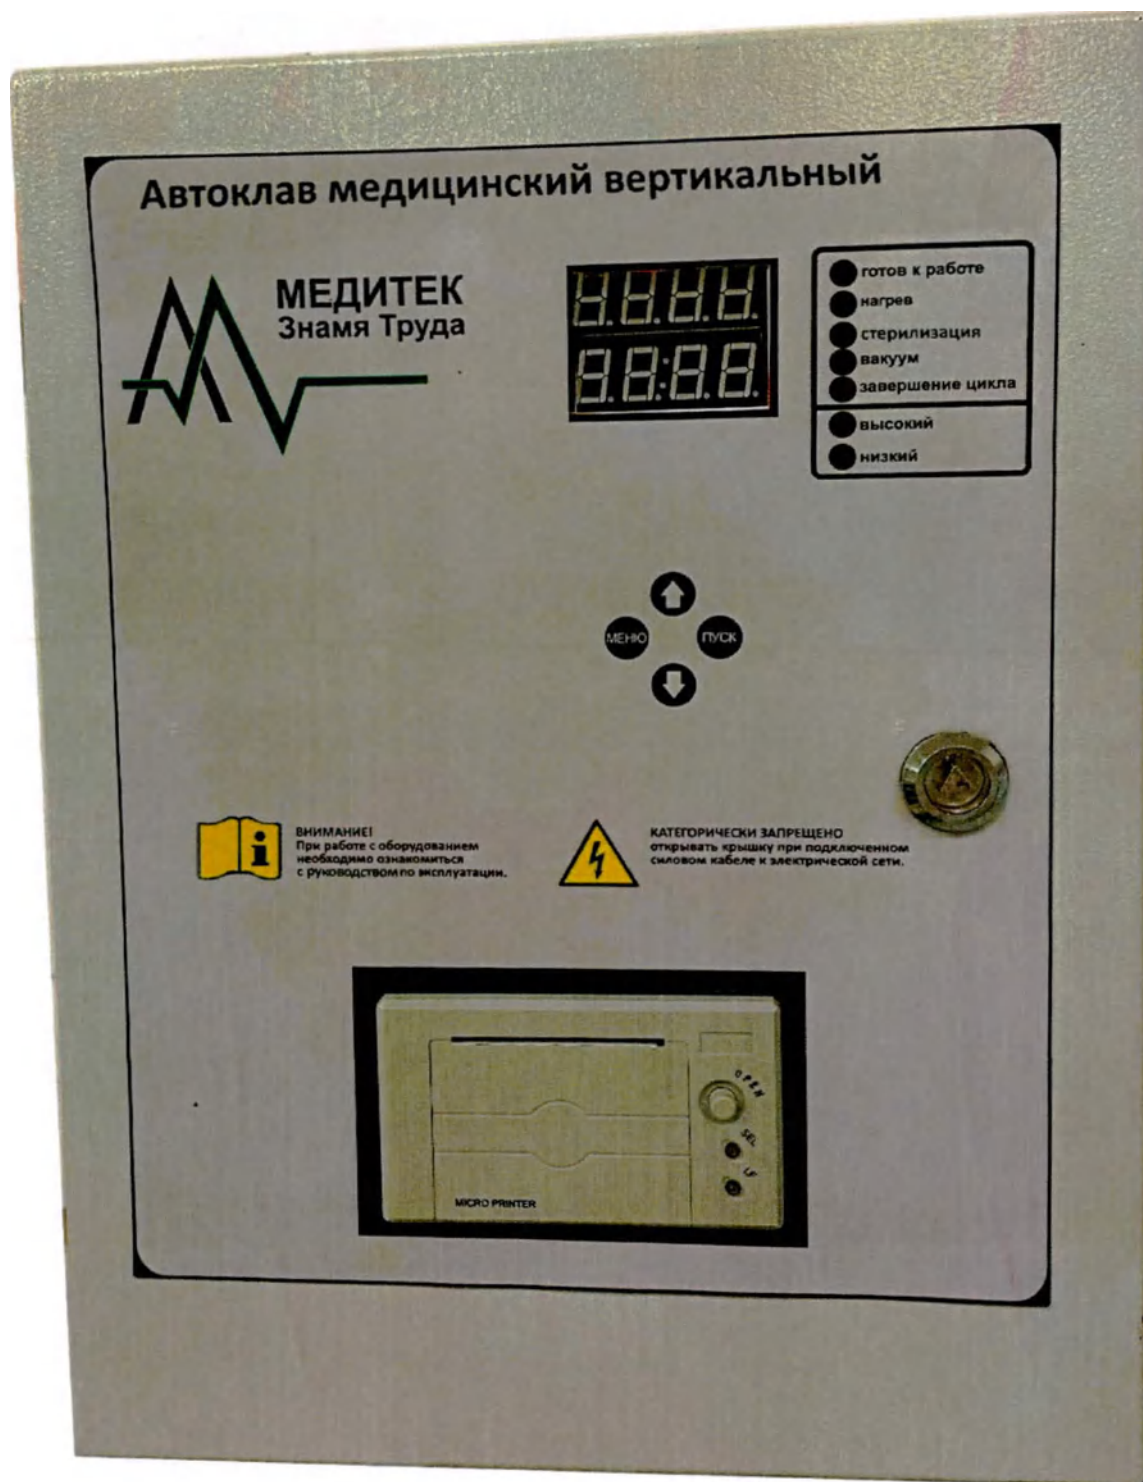




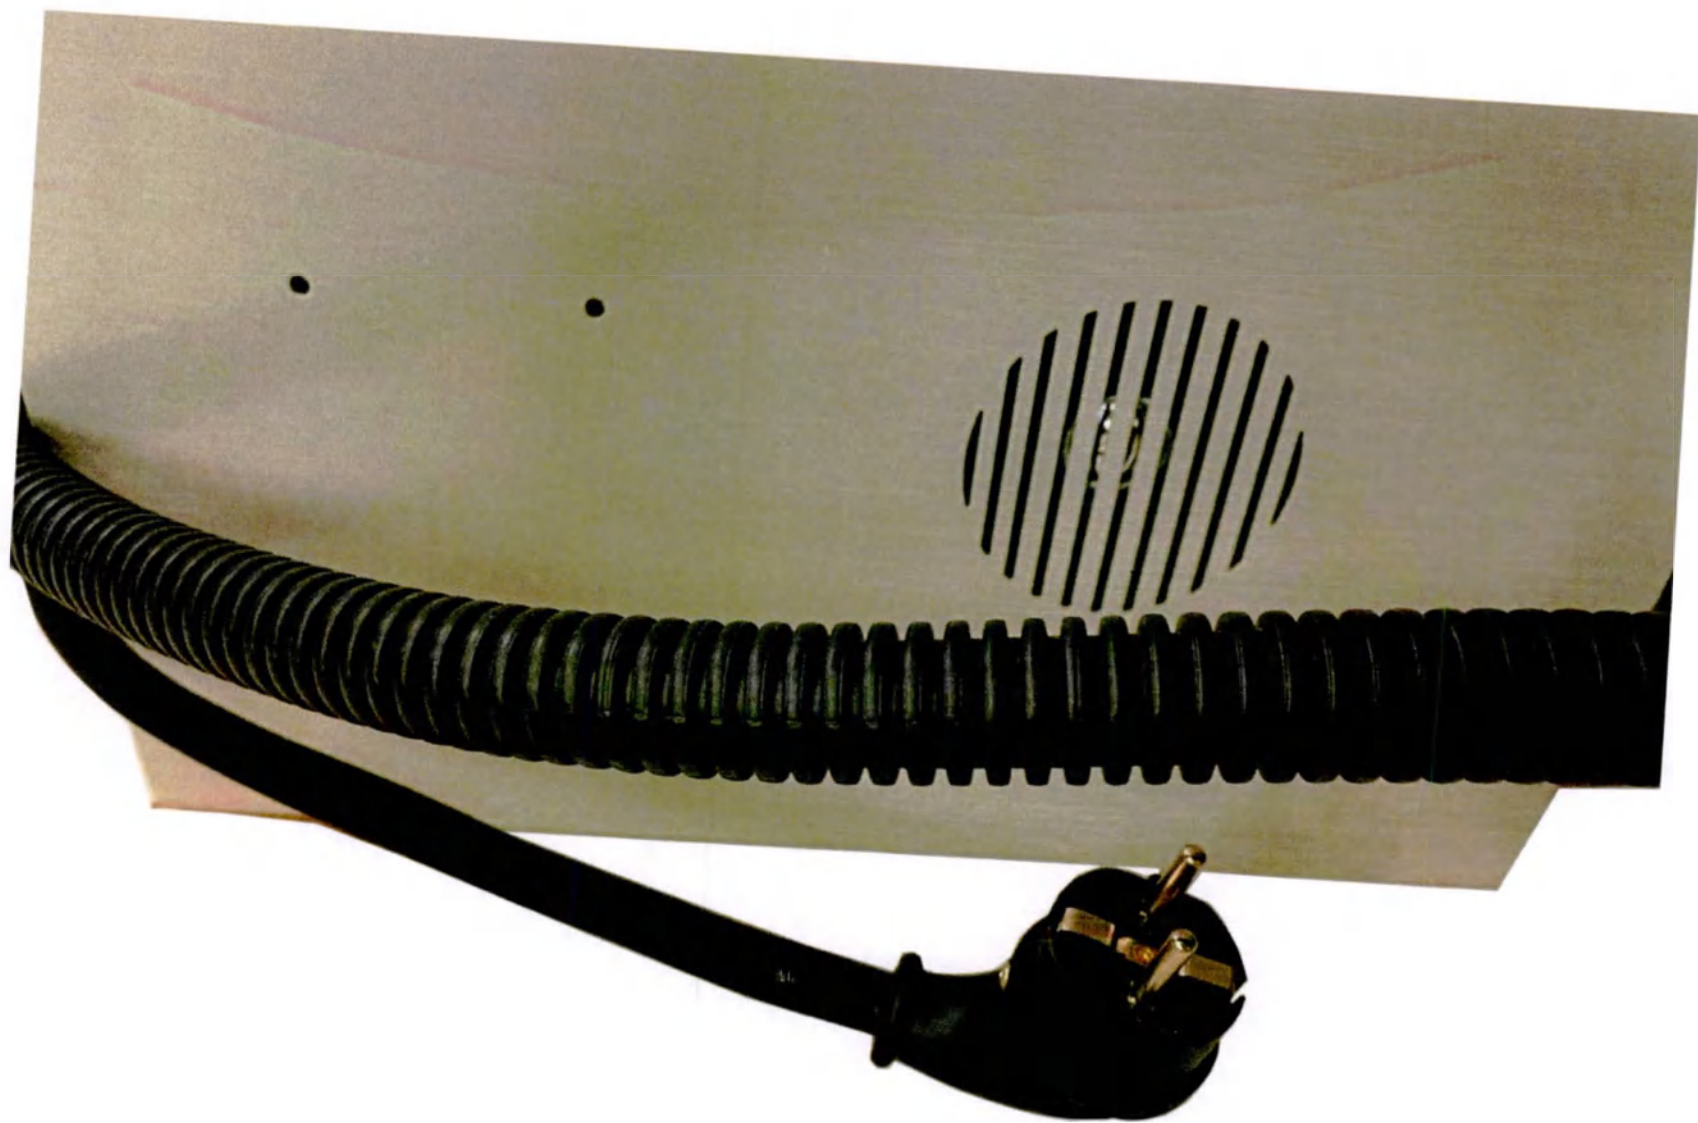

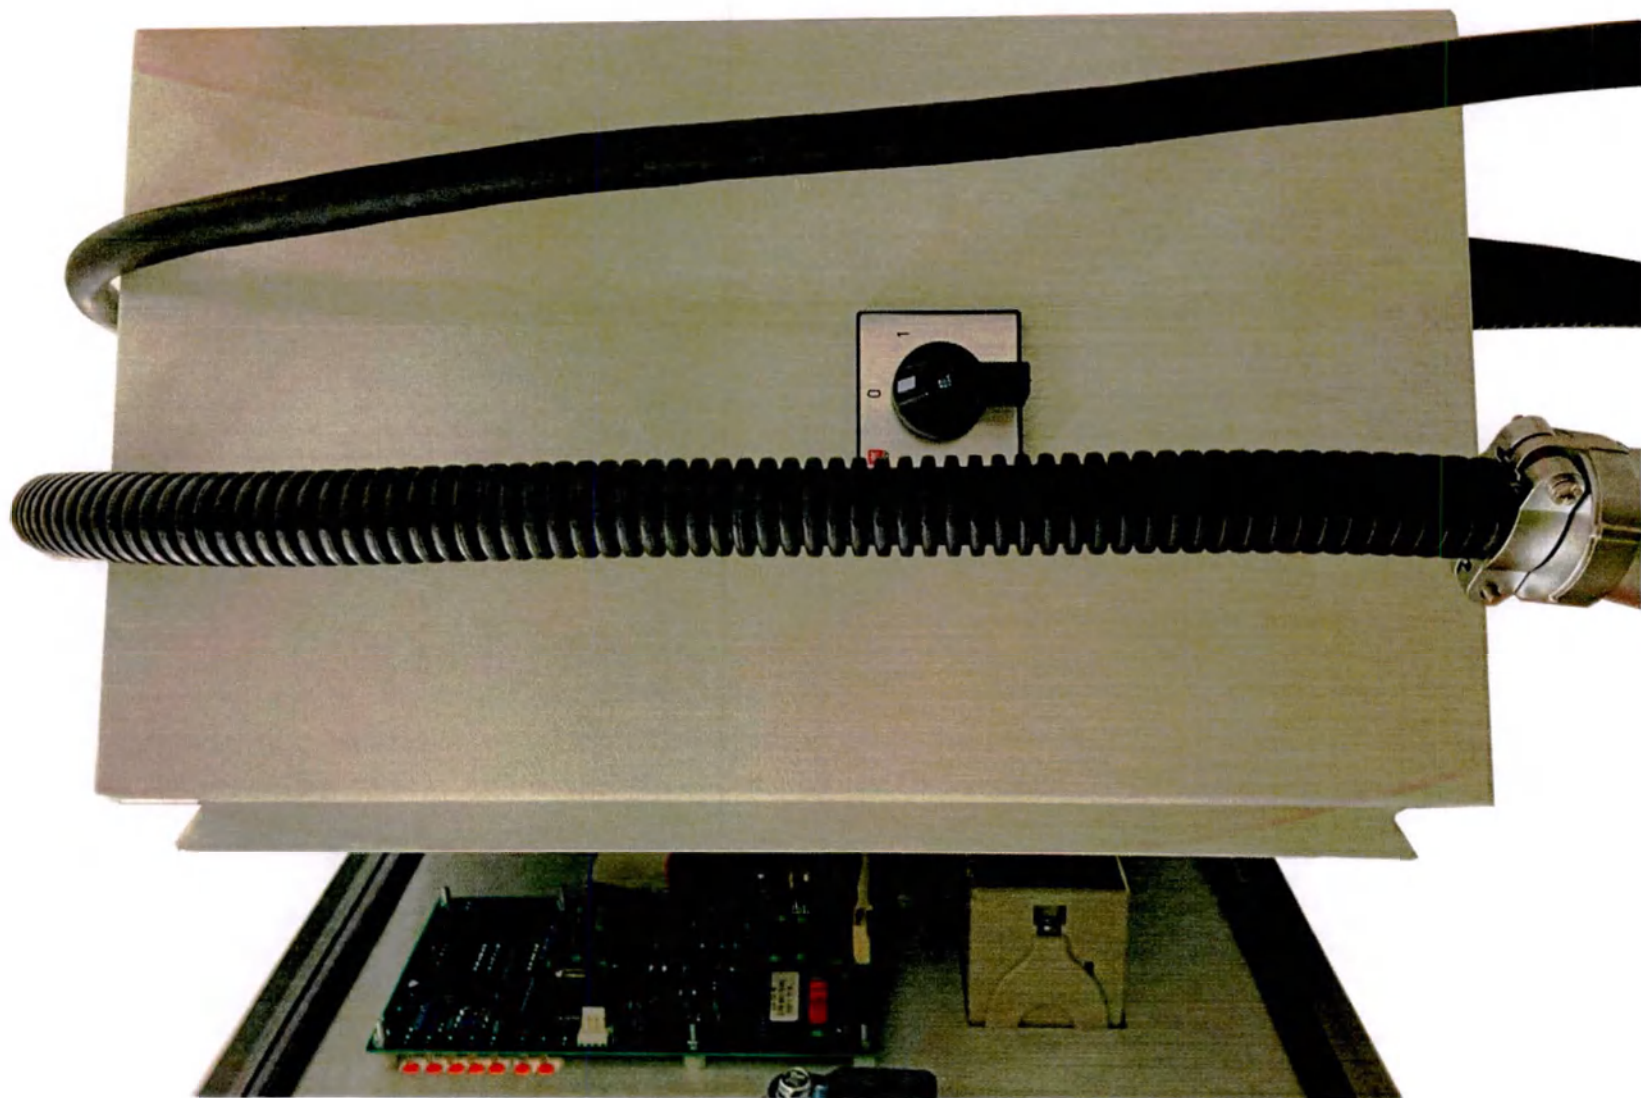


Блок управления модуль 4

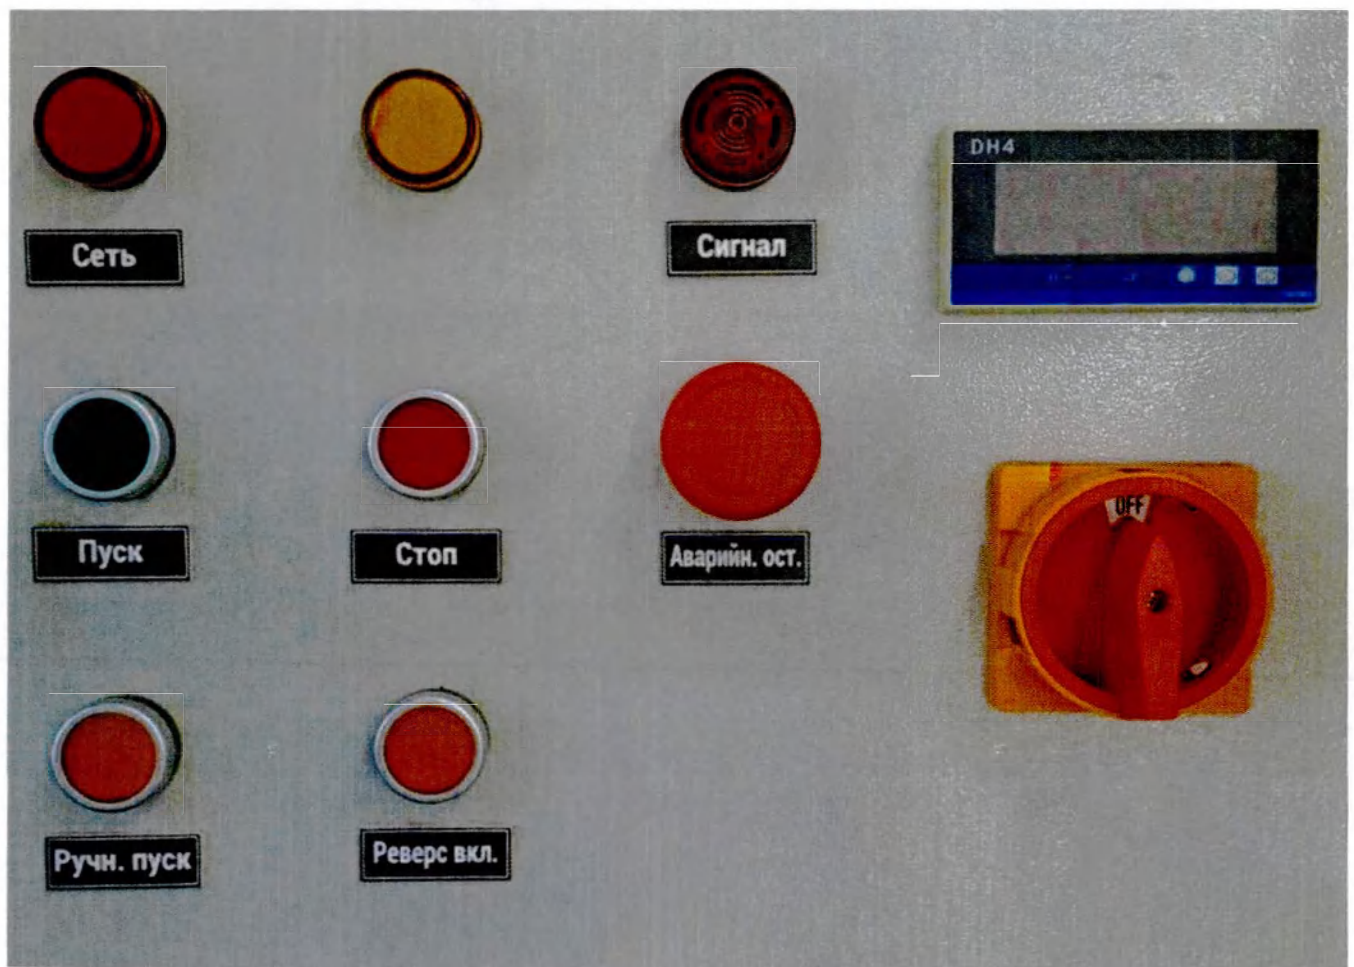



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш300 Б»

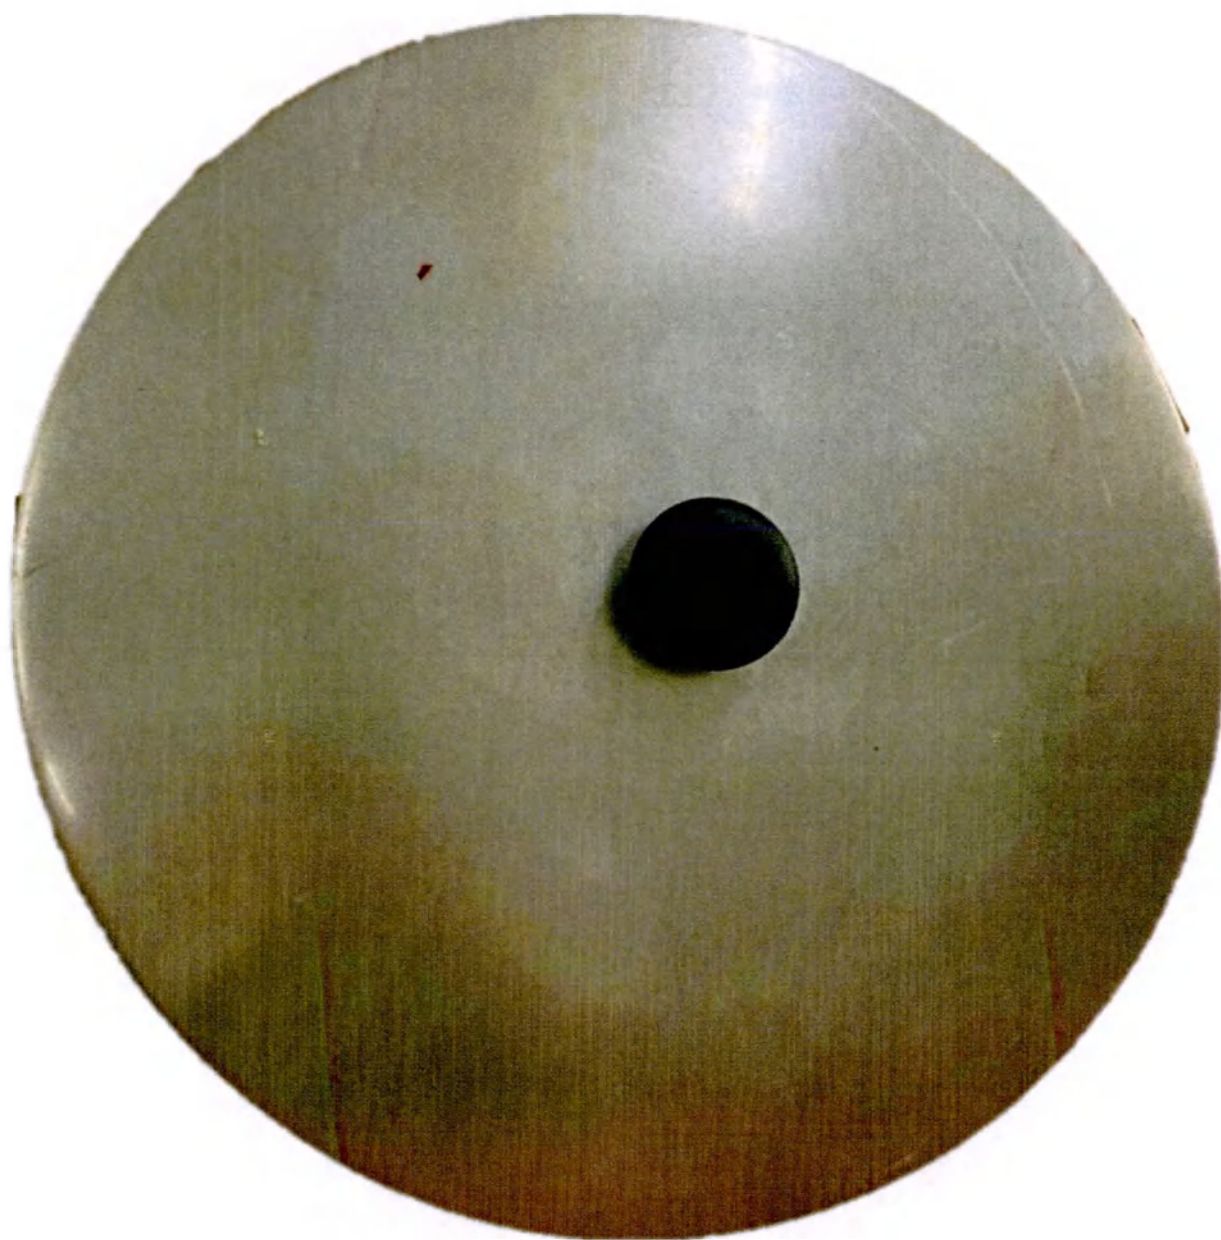

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш300 Б»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



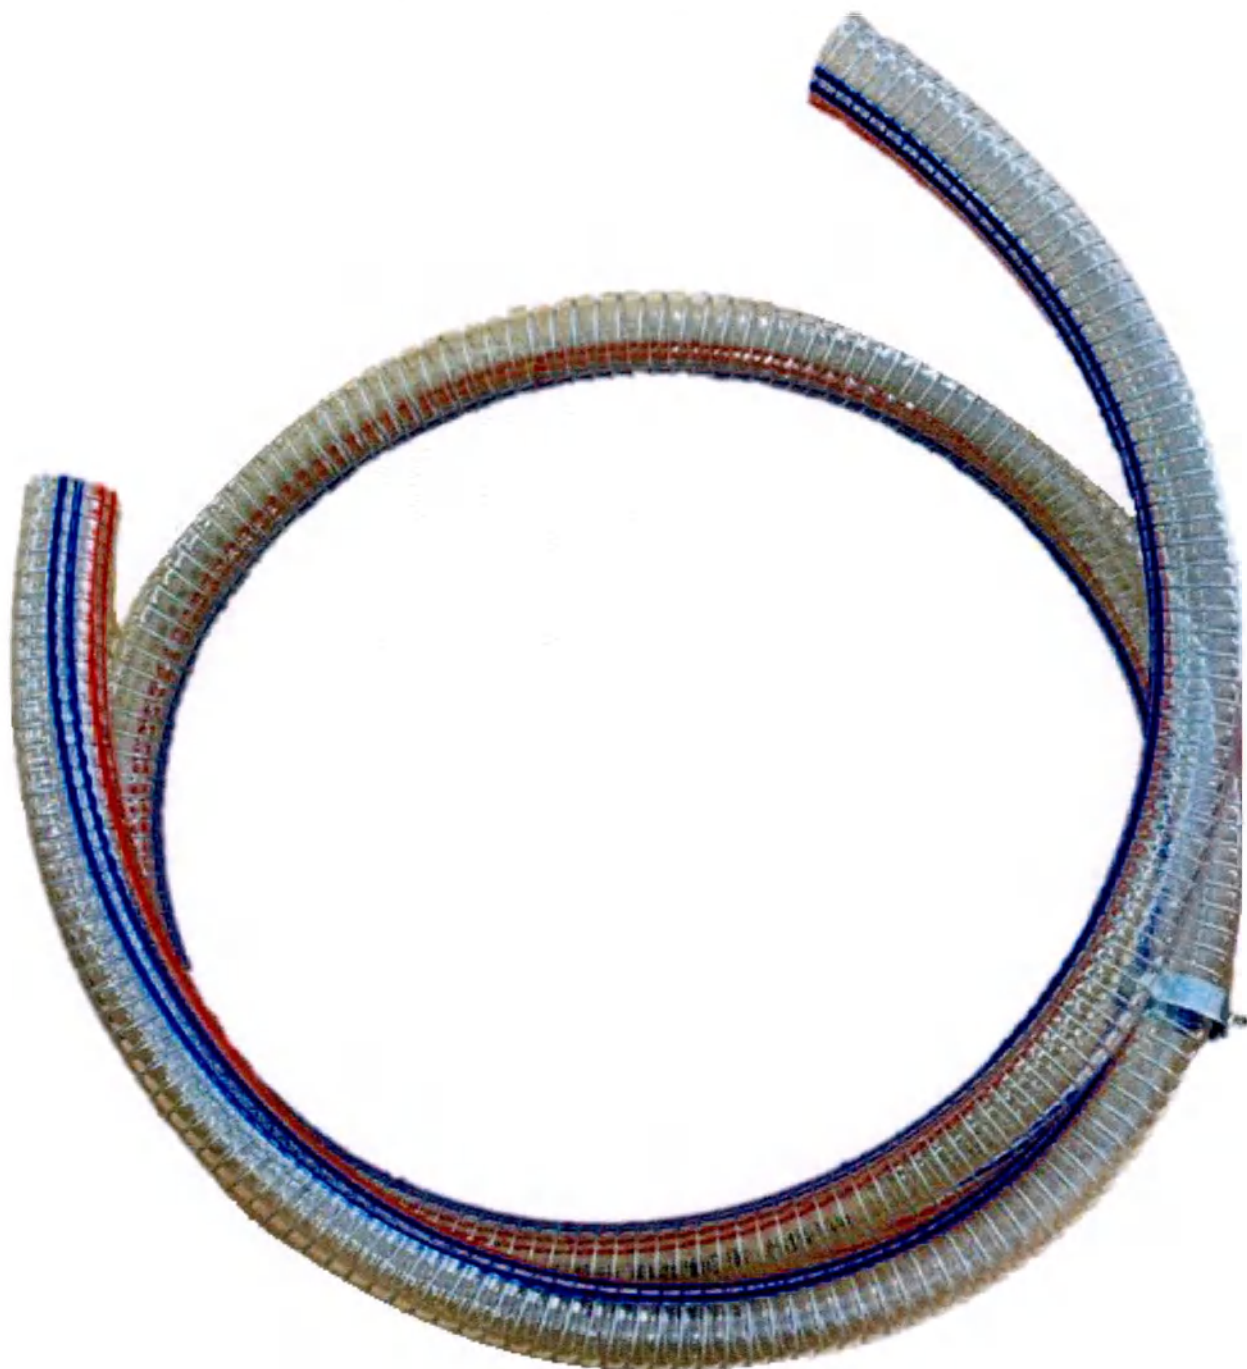

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.

SN

00120/1



РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа


Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.

SN

00120/2



РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Автоклава модуль 1-100

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-100

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВА
Объем стерилизационной камеры: 100 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 00120/3

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Шредер Б модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

 07.2023 г.
 00120

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш300 Б»

**УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ**

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш300 Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00120

12. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш».

Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш200 гор Б»

Автоклав модуль 1-200 (загрузочная сторона)



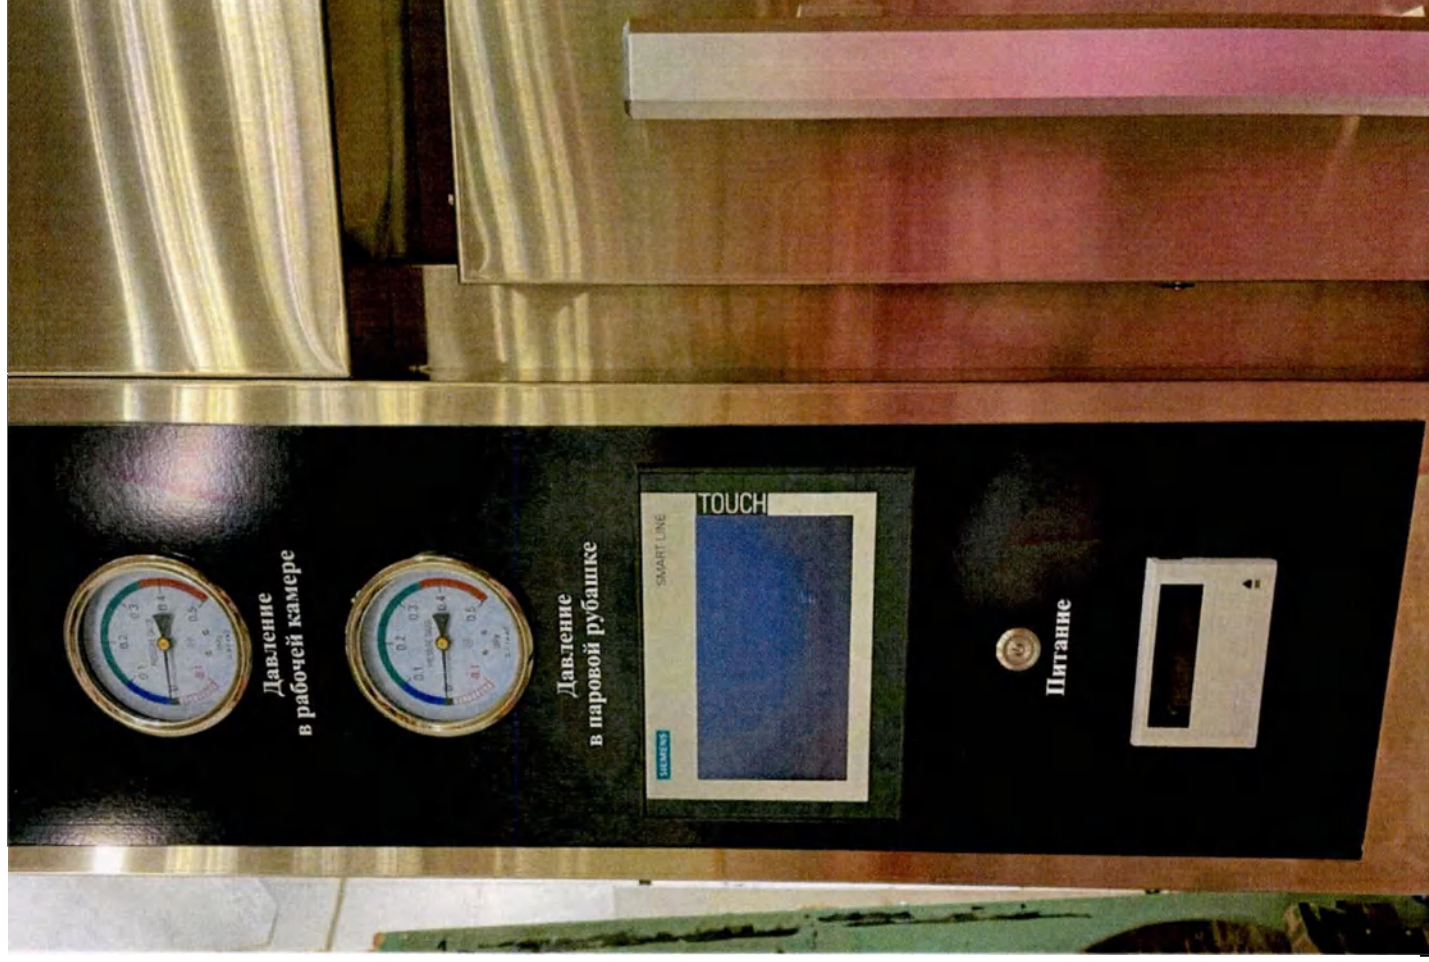


Автоклав модуль 1-200 (разгрузочная сторона)






Шредер Б модуль 2



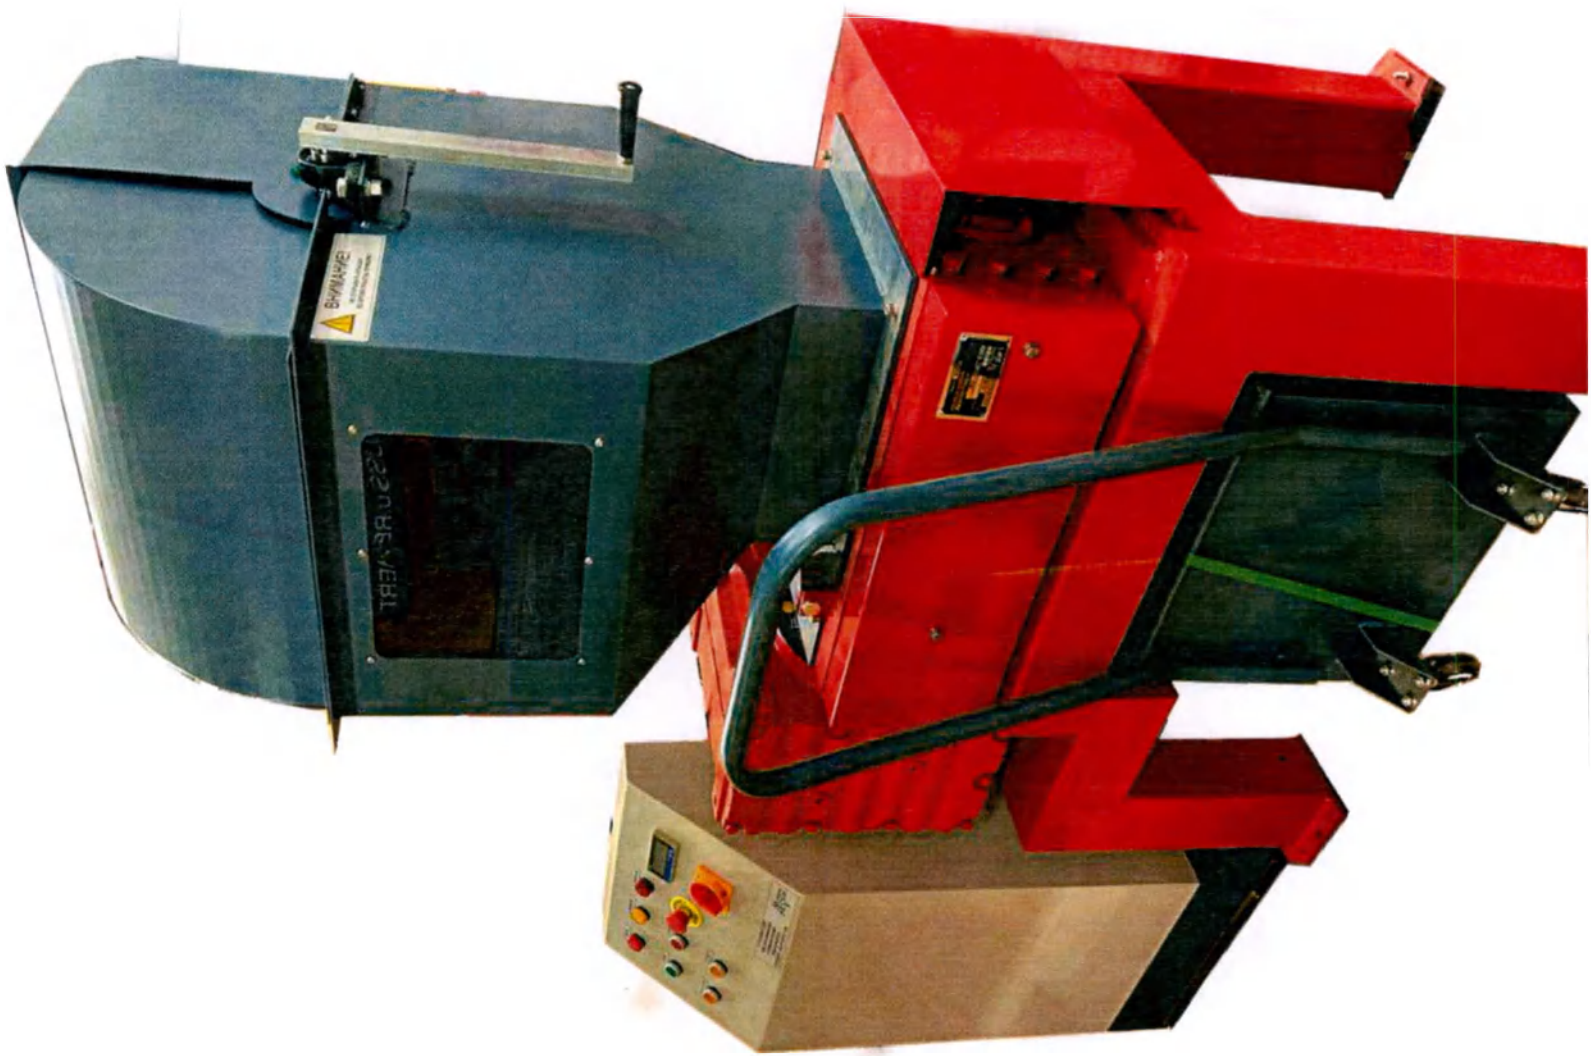

Блок управления модуль 4

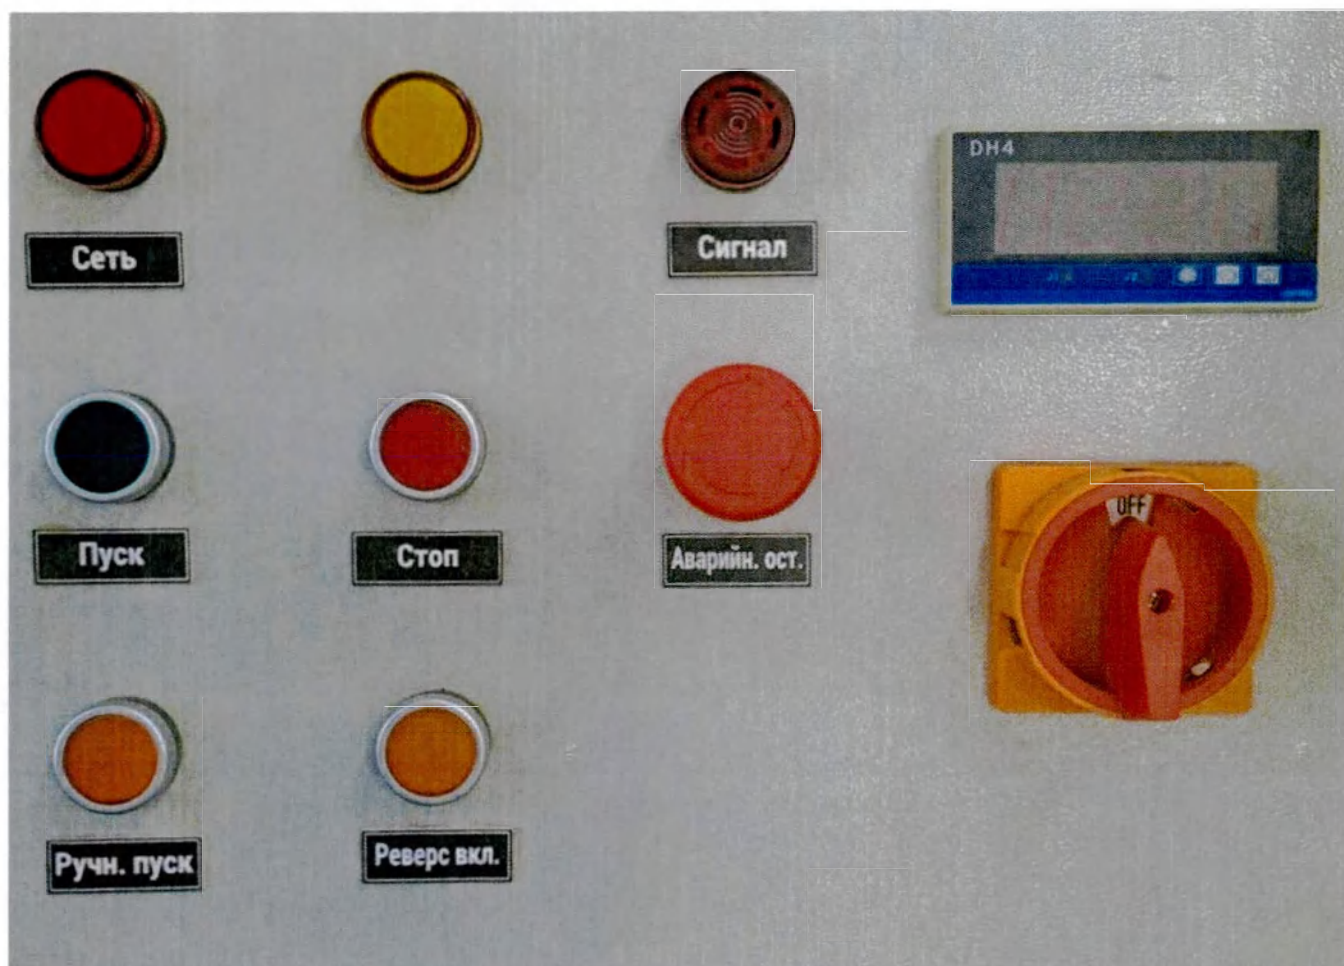

Решетка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 гор Б»



Маркировка Автоклав модуль 1-200



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-200



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 380 В, 3~50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 23,5 кВА

Объем стерилизационной камеры: 200 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,225 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,019 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.06.2023 г.



00102



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер Б модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер Б модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА



07.2023 г.



00102



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш200 гор Б»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш200 гор Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.

SN

00102

13. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш».

Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш280 гор Б»

Автоклав модуль 1-280 (загрузочная сторона)






Автоклав модуль 1-280 (разгрузочная сторона)






Шредер Б модуль 2



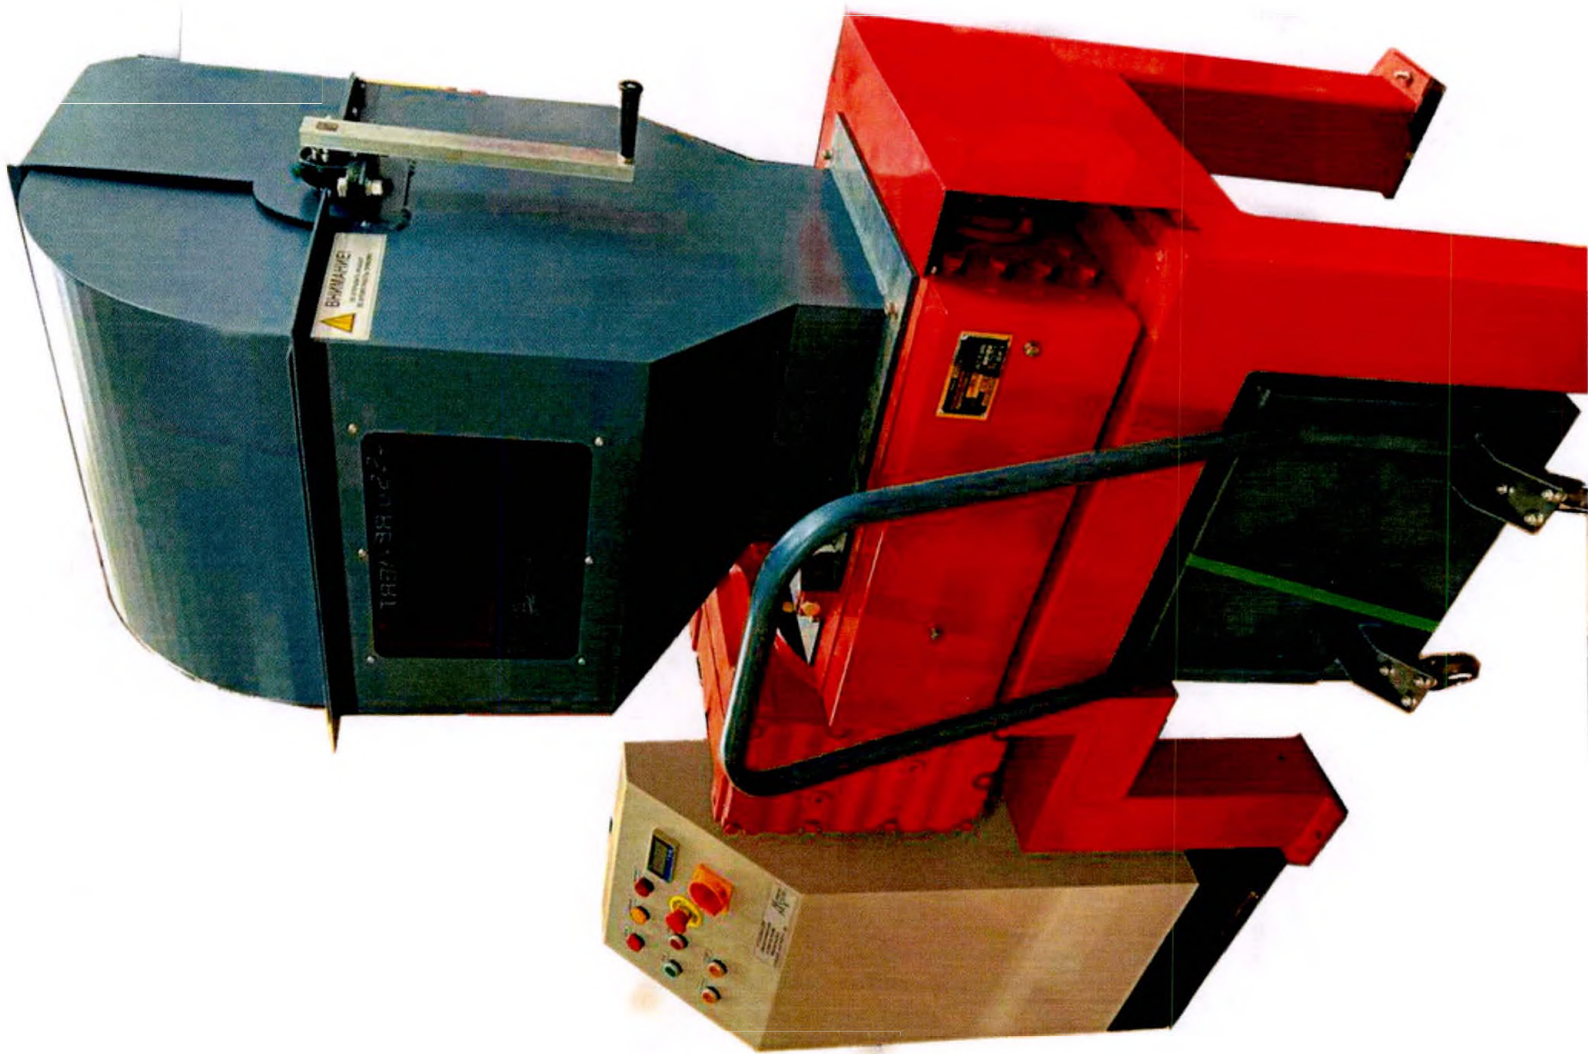

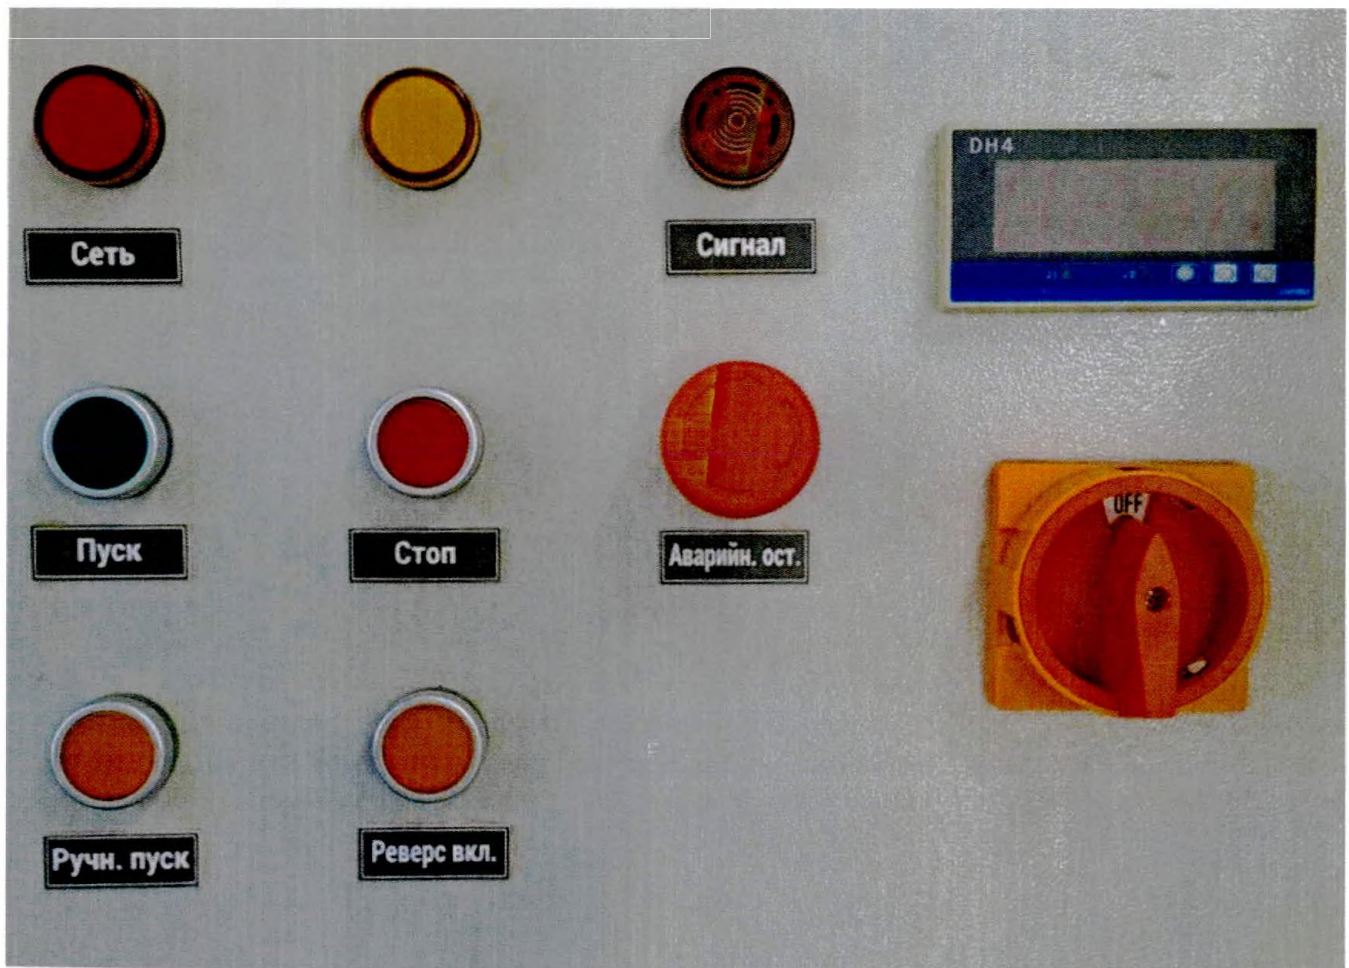

Решетка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш280 гор Б»



Маркировка Автоклава модуль 1-280

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-280

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 26,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 280 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,225 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,019 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 00103

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Шредер Б модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер Б модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

 07.2023 г.
 00103

    РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш280 гор Б»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш280 гор Б»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А


Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см




07.2023 г.




00103


14. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш15 НБ»

Автоклав модуль 1-15

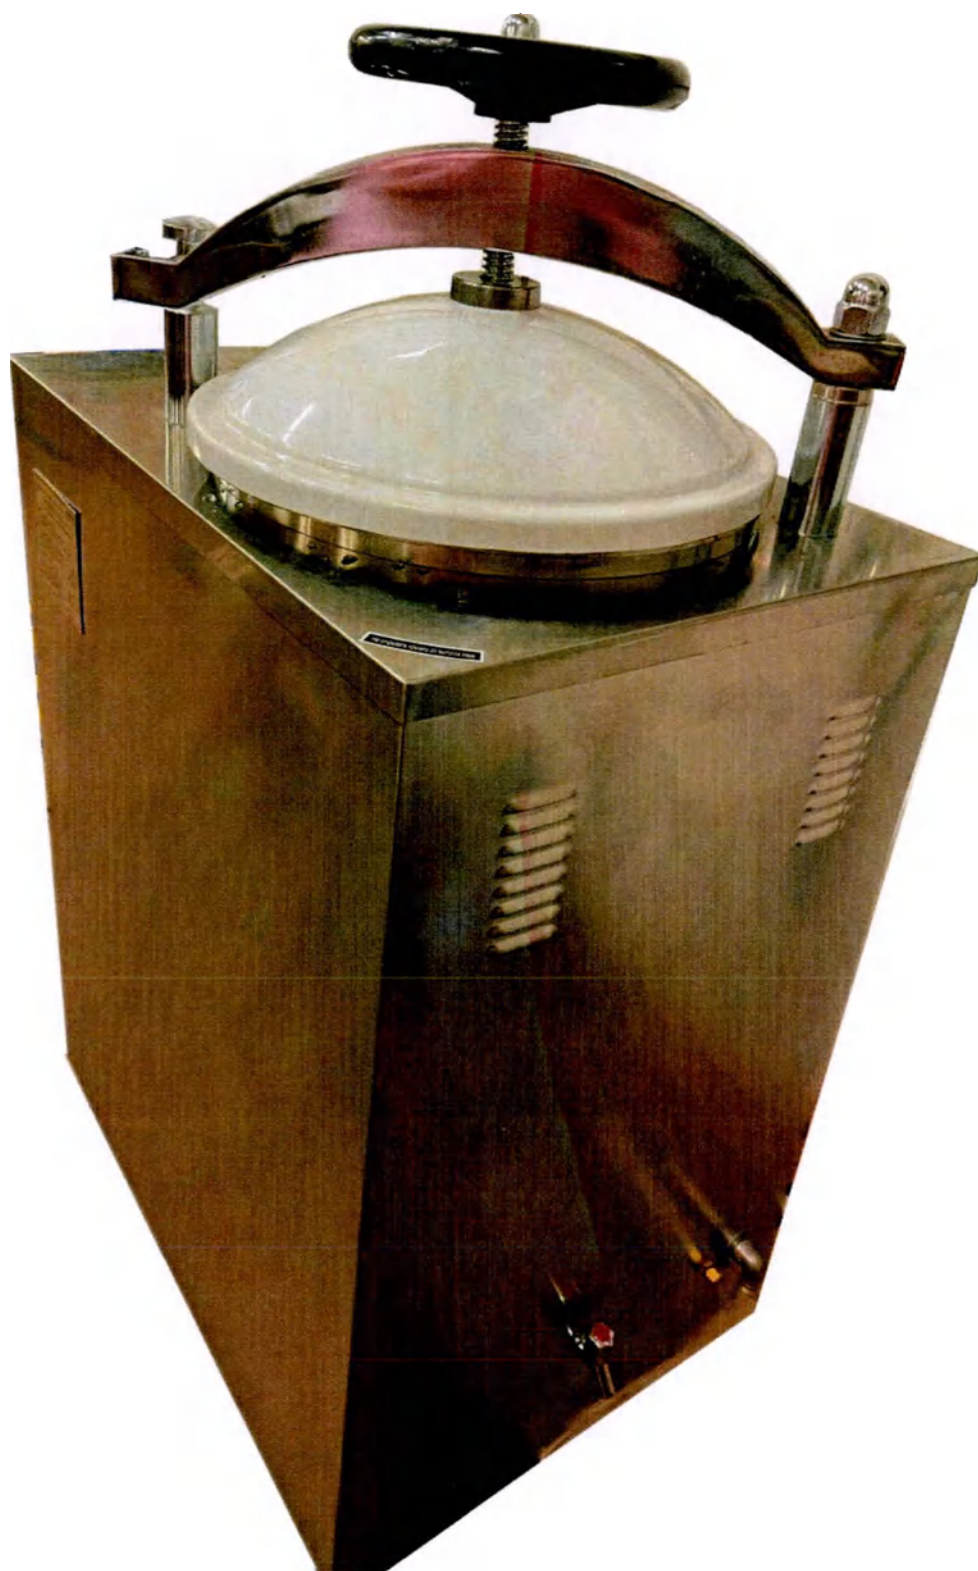

Камера автоклава модуль 1-15

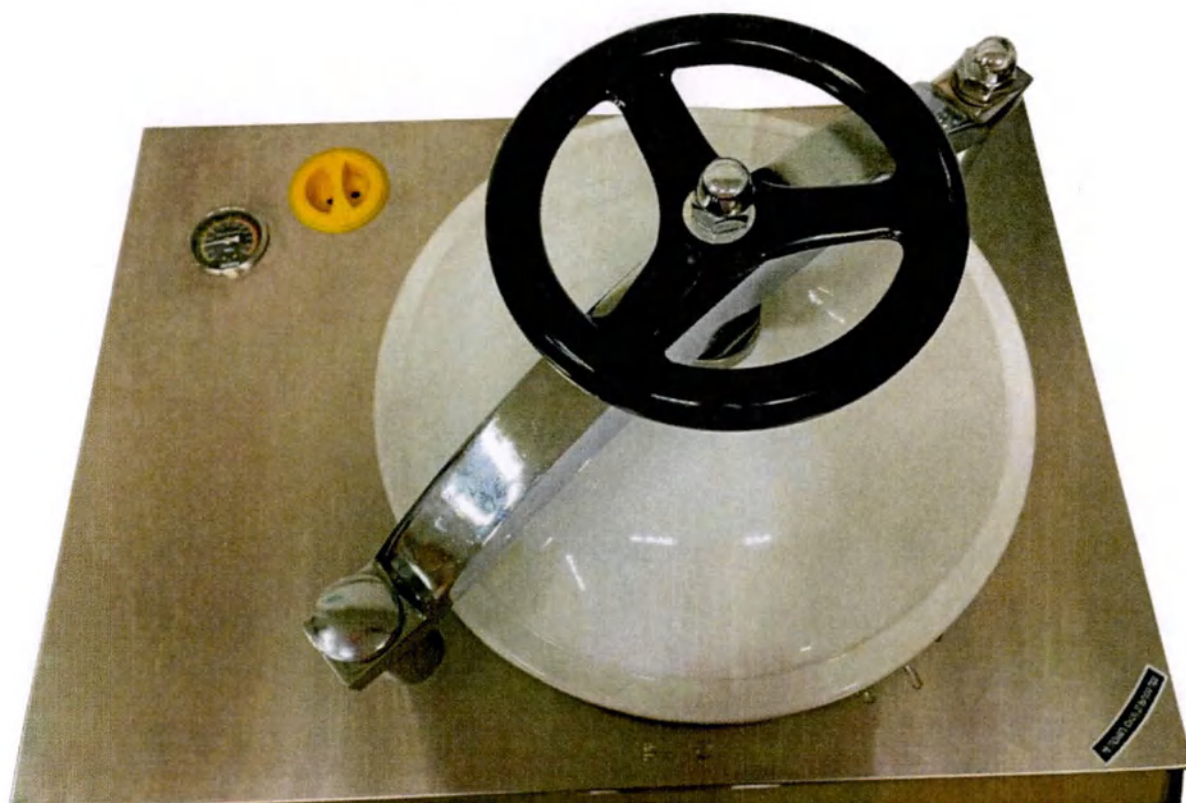


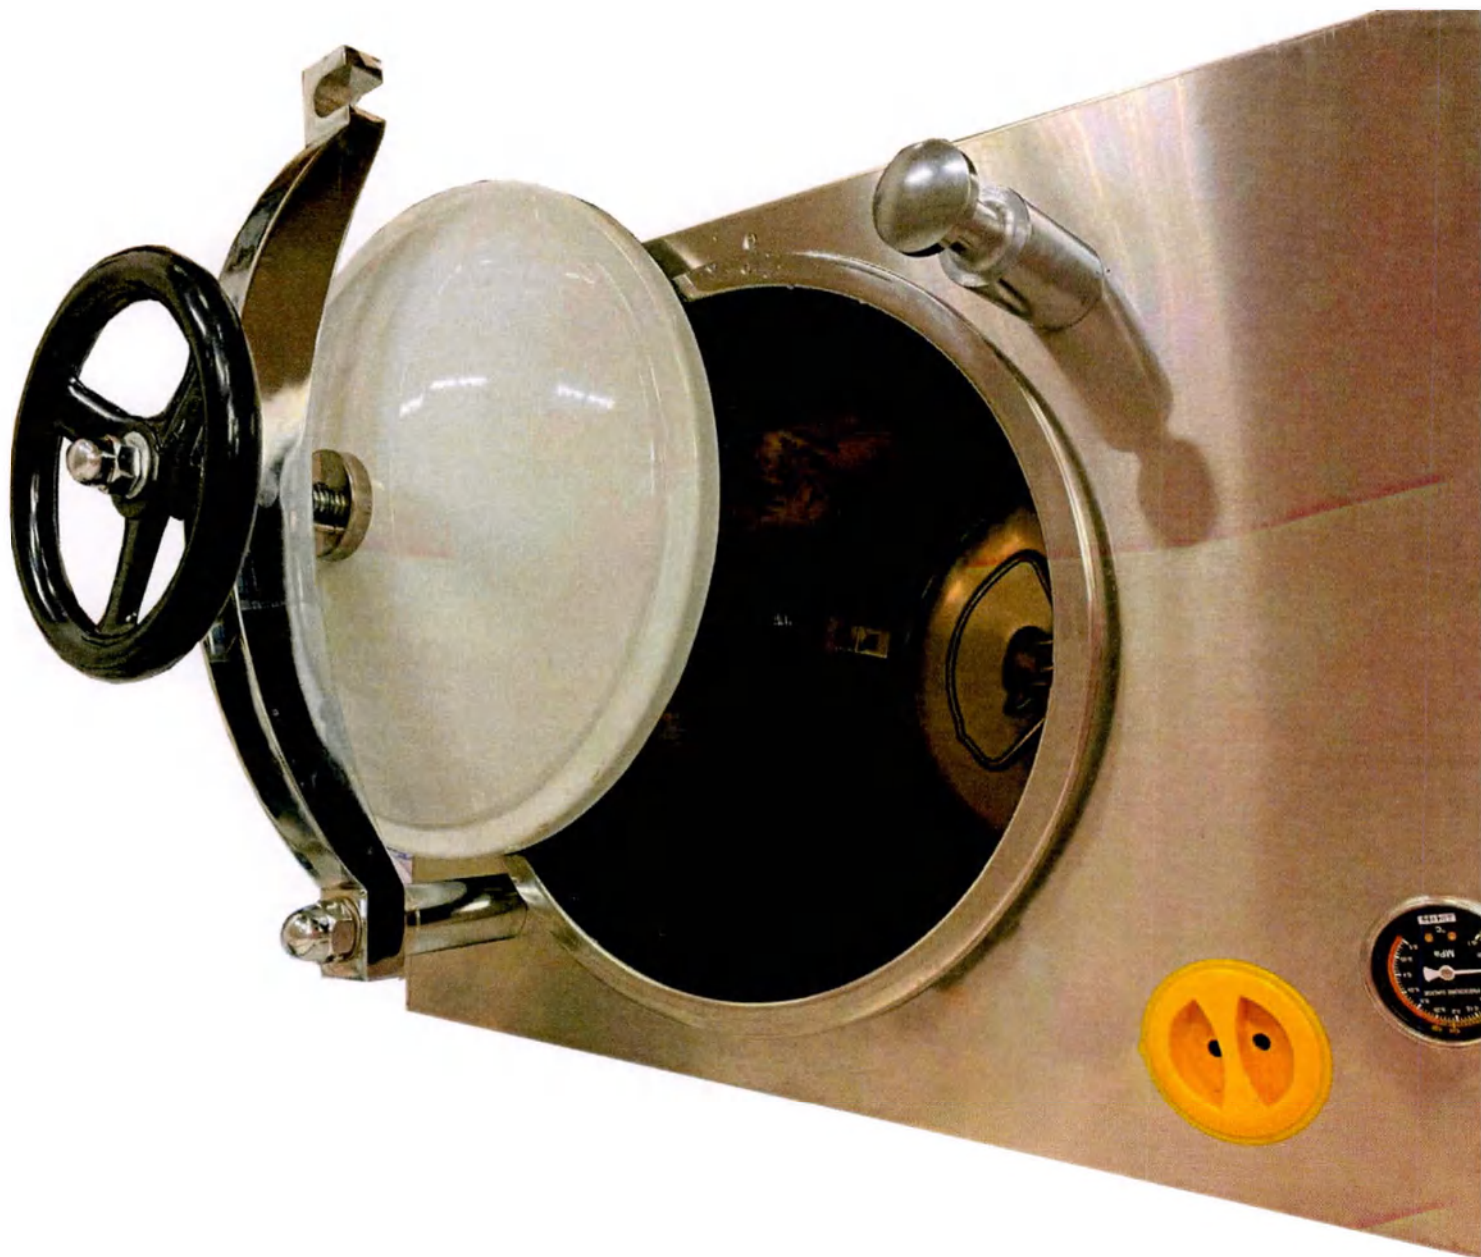



Шредер НБ модуль 2





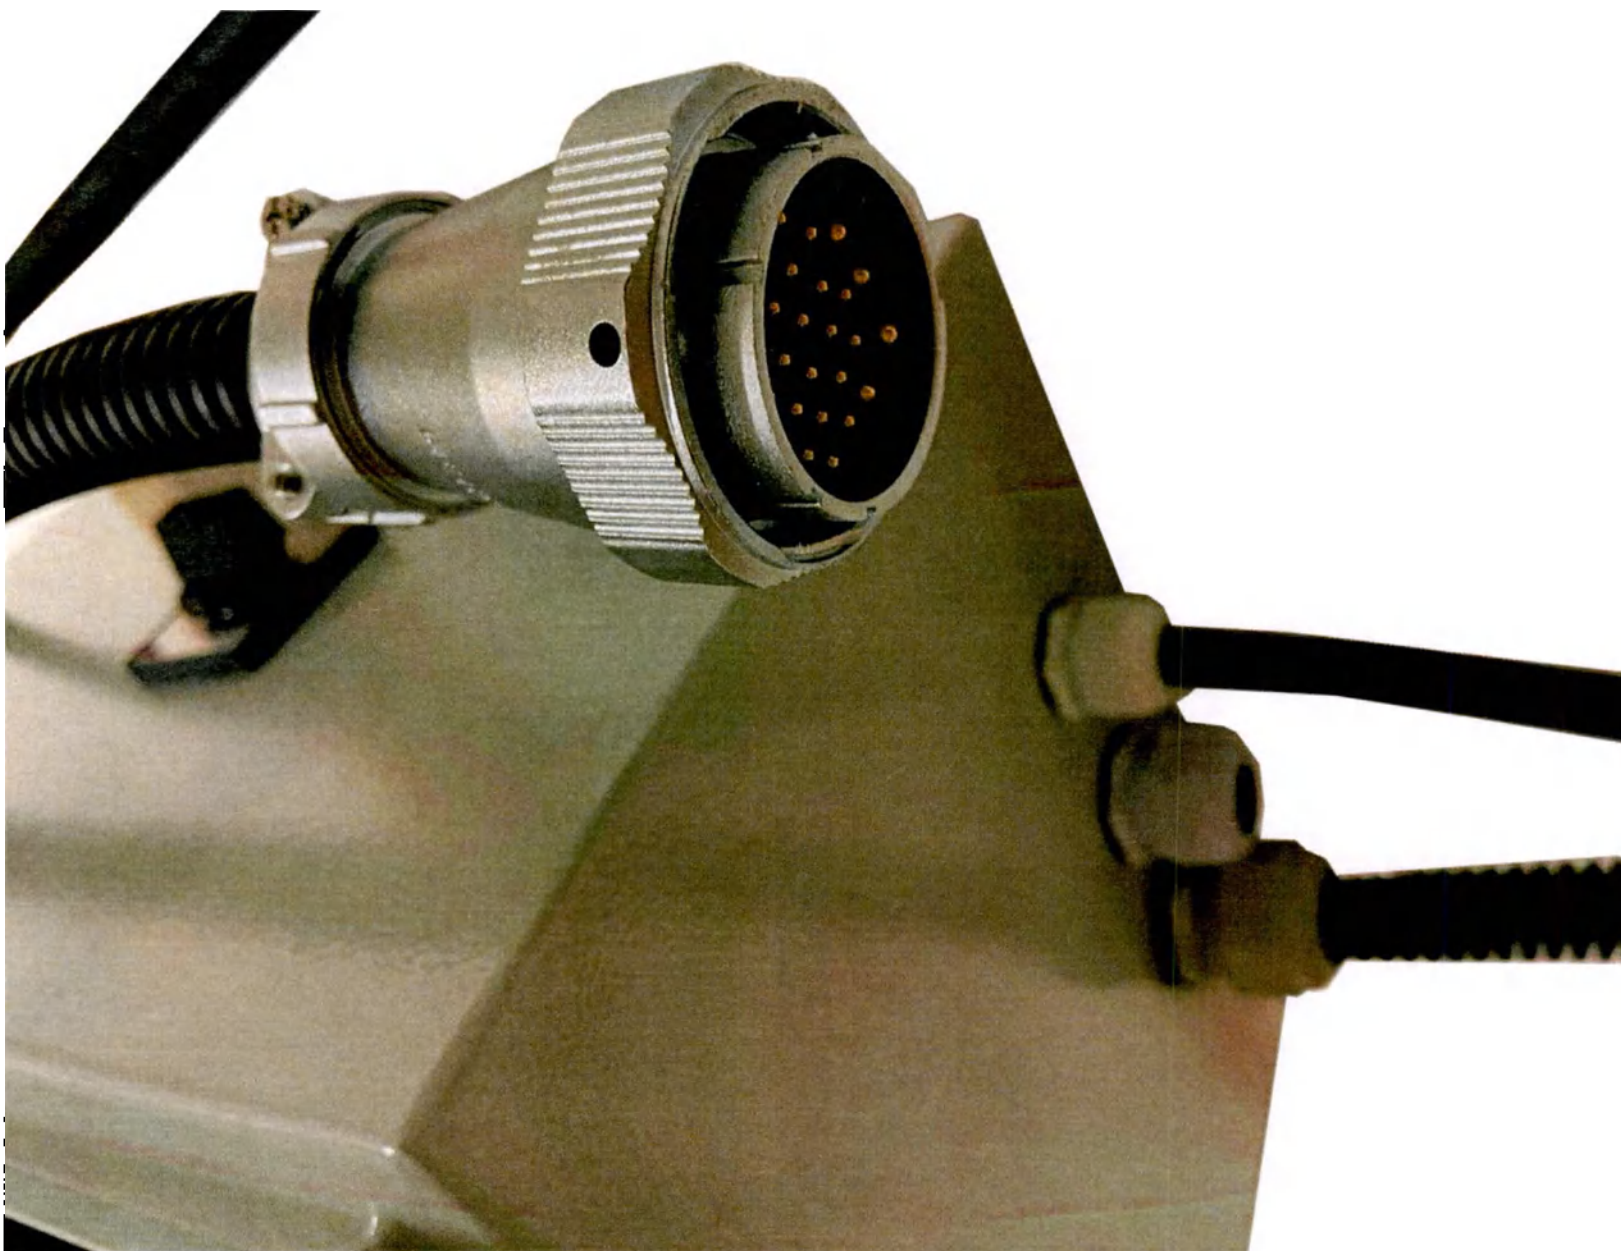

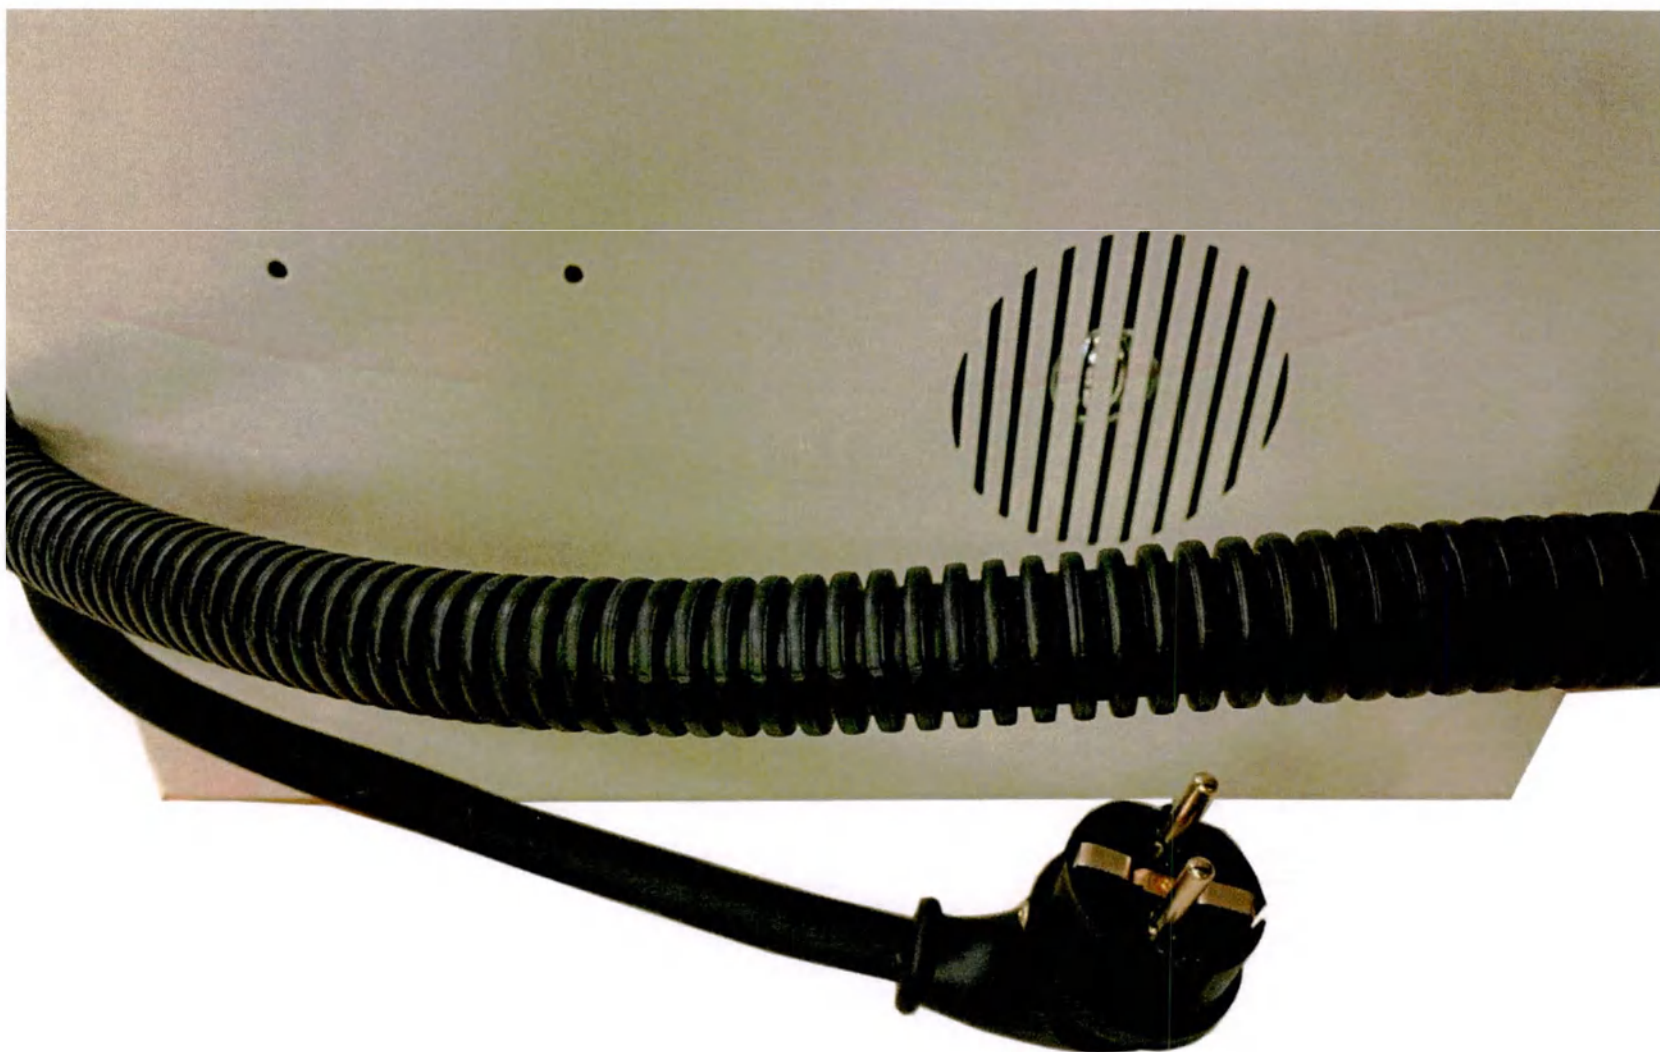

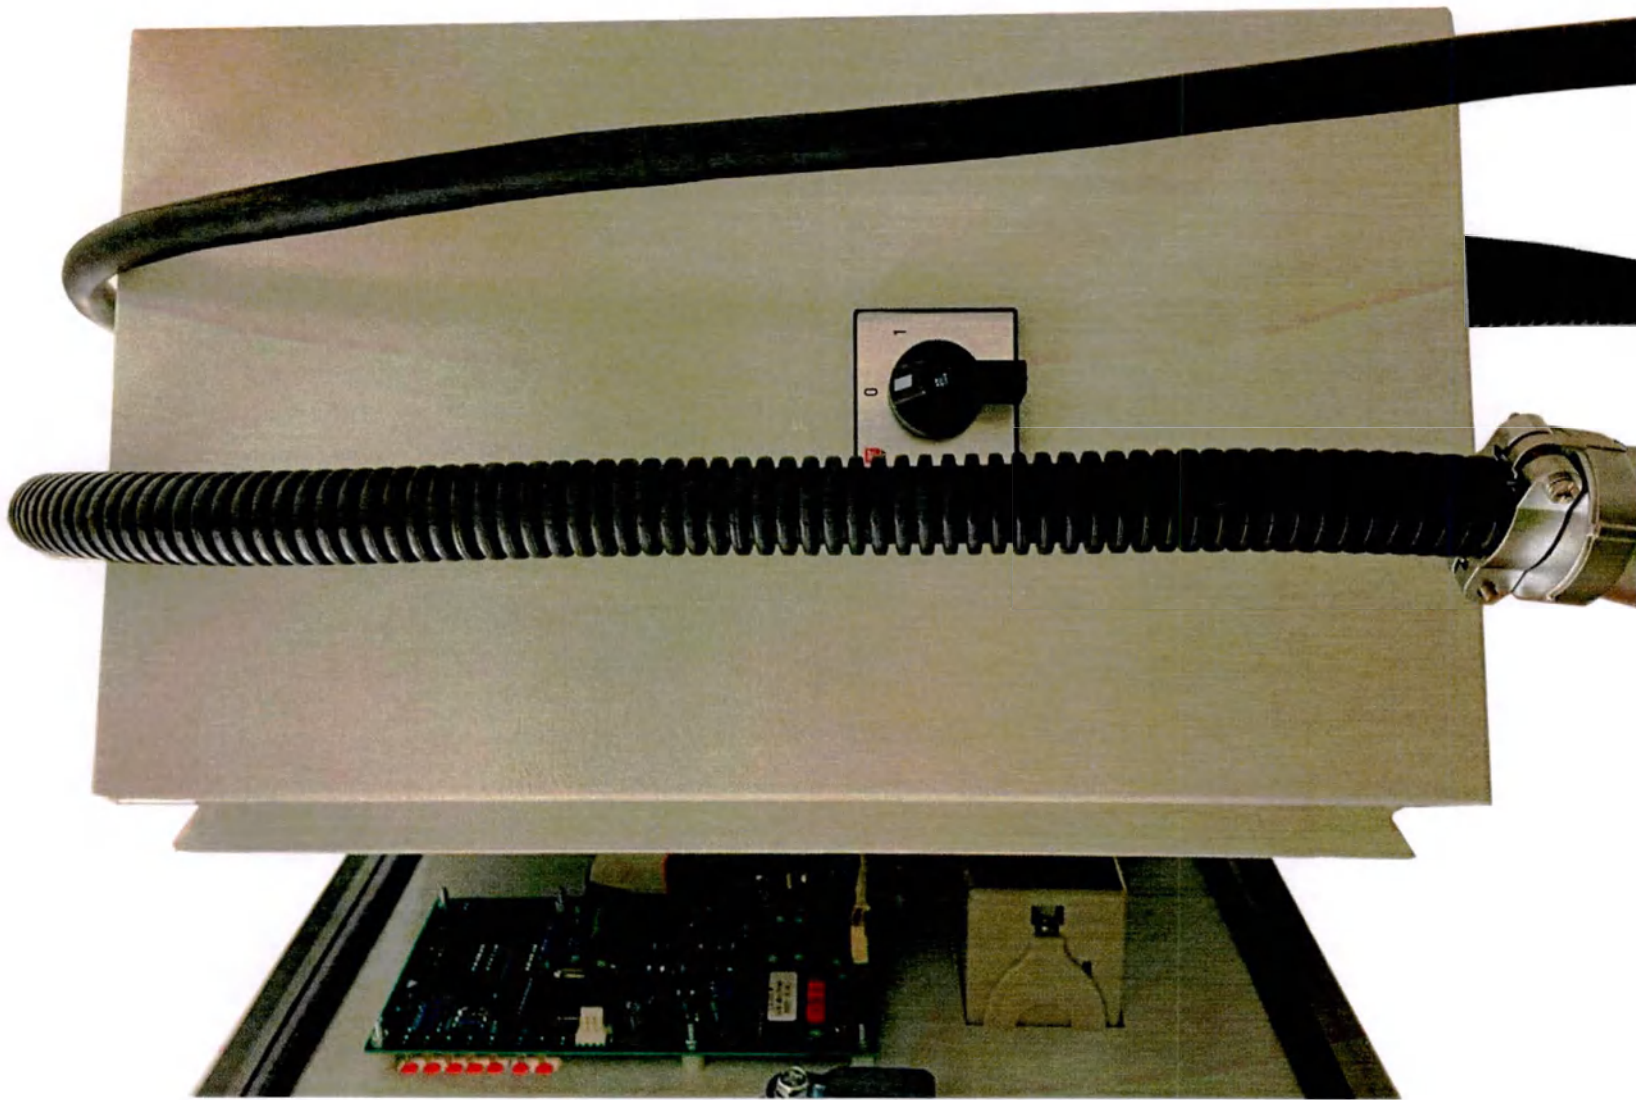

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш15 НБ»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш15 НБ»



Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш15 НБ»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



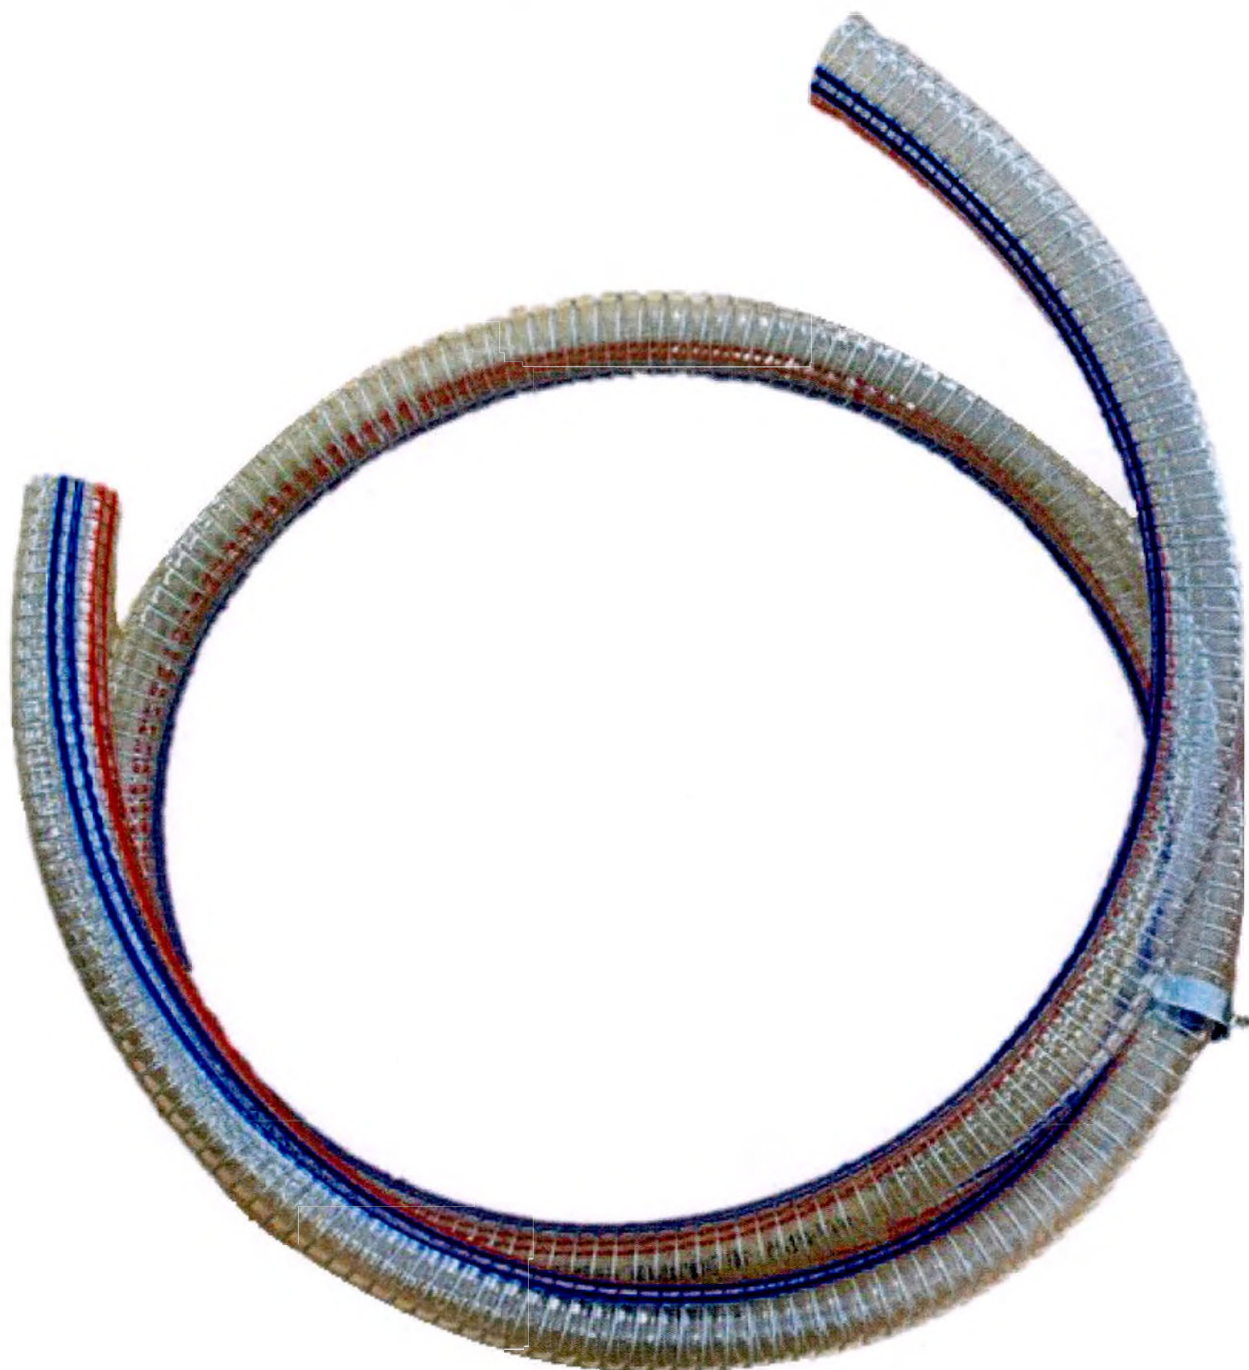

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-15



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-15



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 2,0 кВА

Объем стерилизационной камеры: 15 л

Максимальная рабочая температура: 126°C

Максимальное рабочее давление: 0,15 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00121



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер НБ модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер НБ модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА



07.2023 г.



00121



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш15 НБ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш15 НБ»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,

наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.



00121





15. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш30 НБ»

Автоклав модуль 1-30





Камера автоклава модуль 1-30

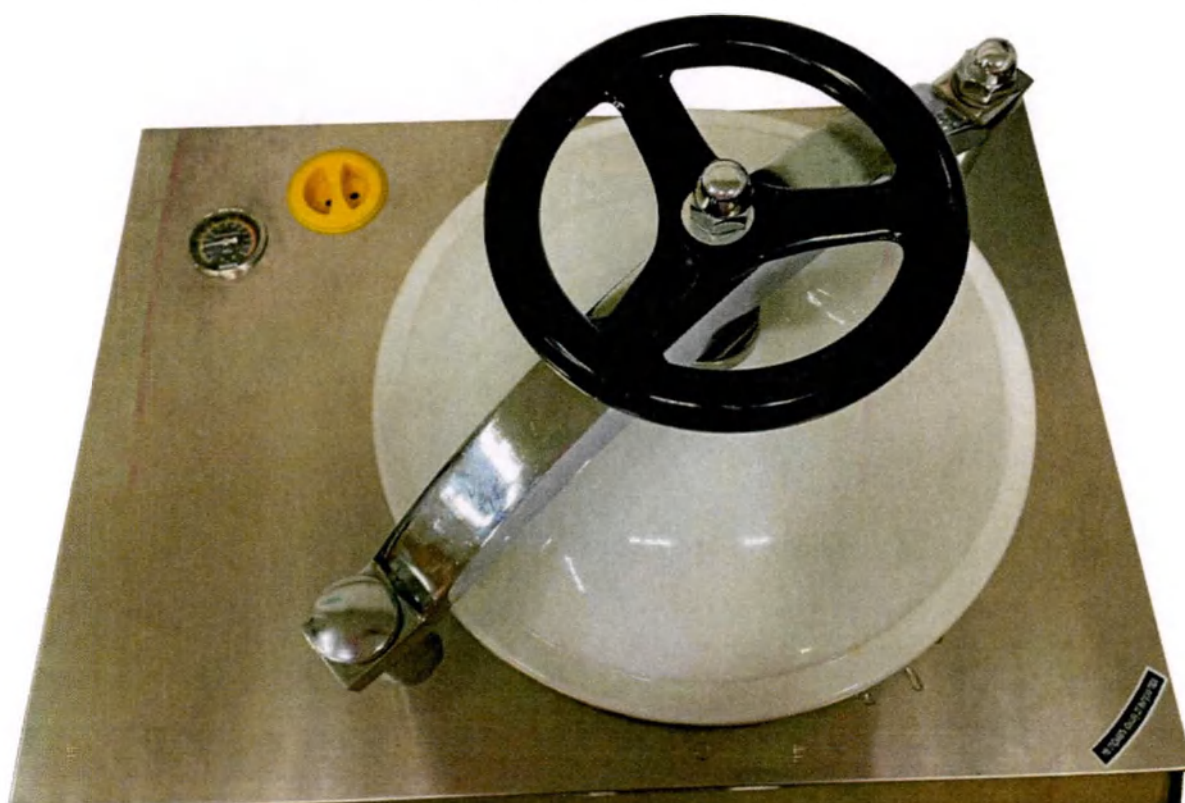


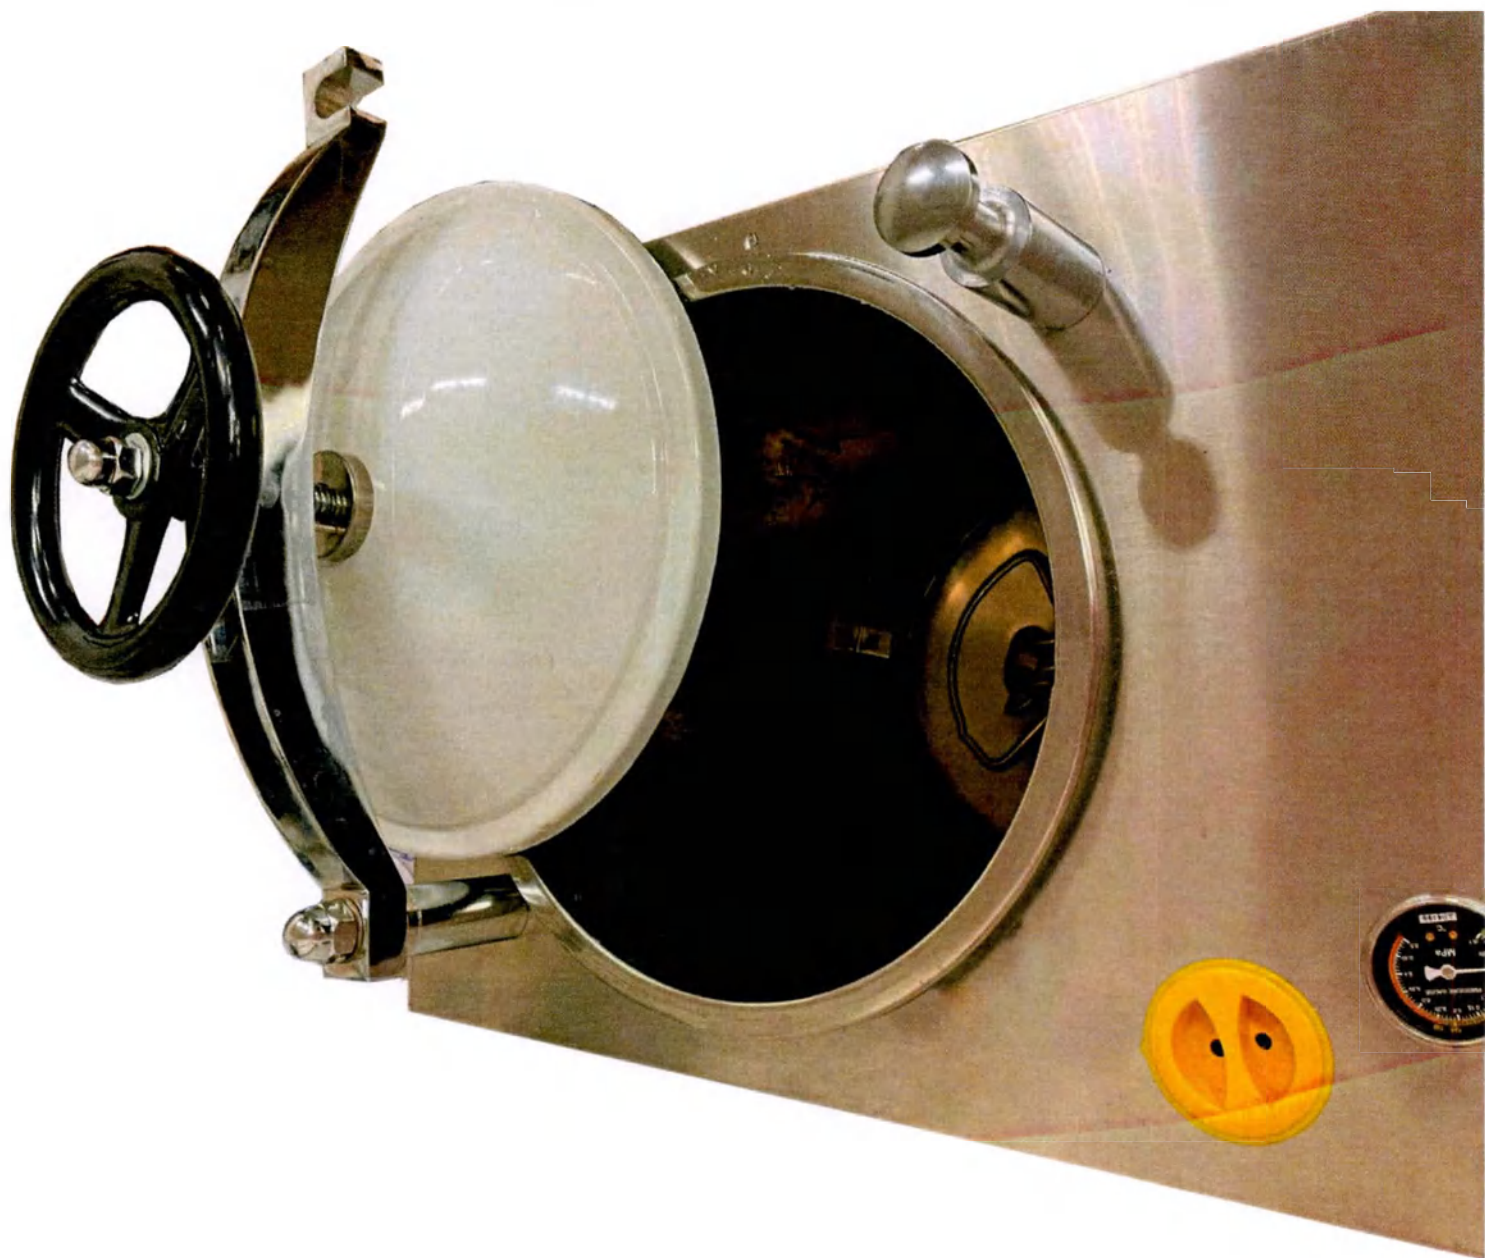




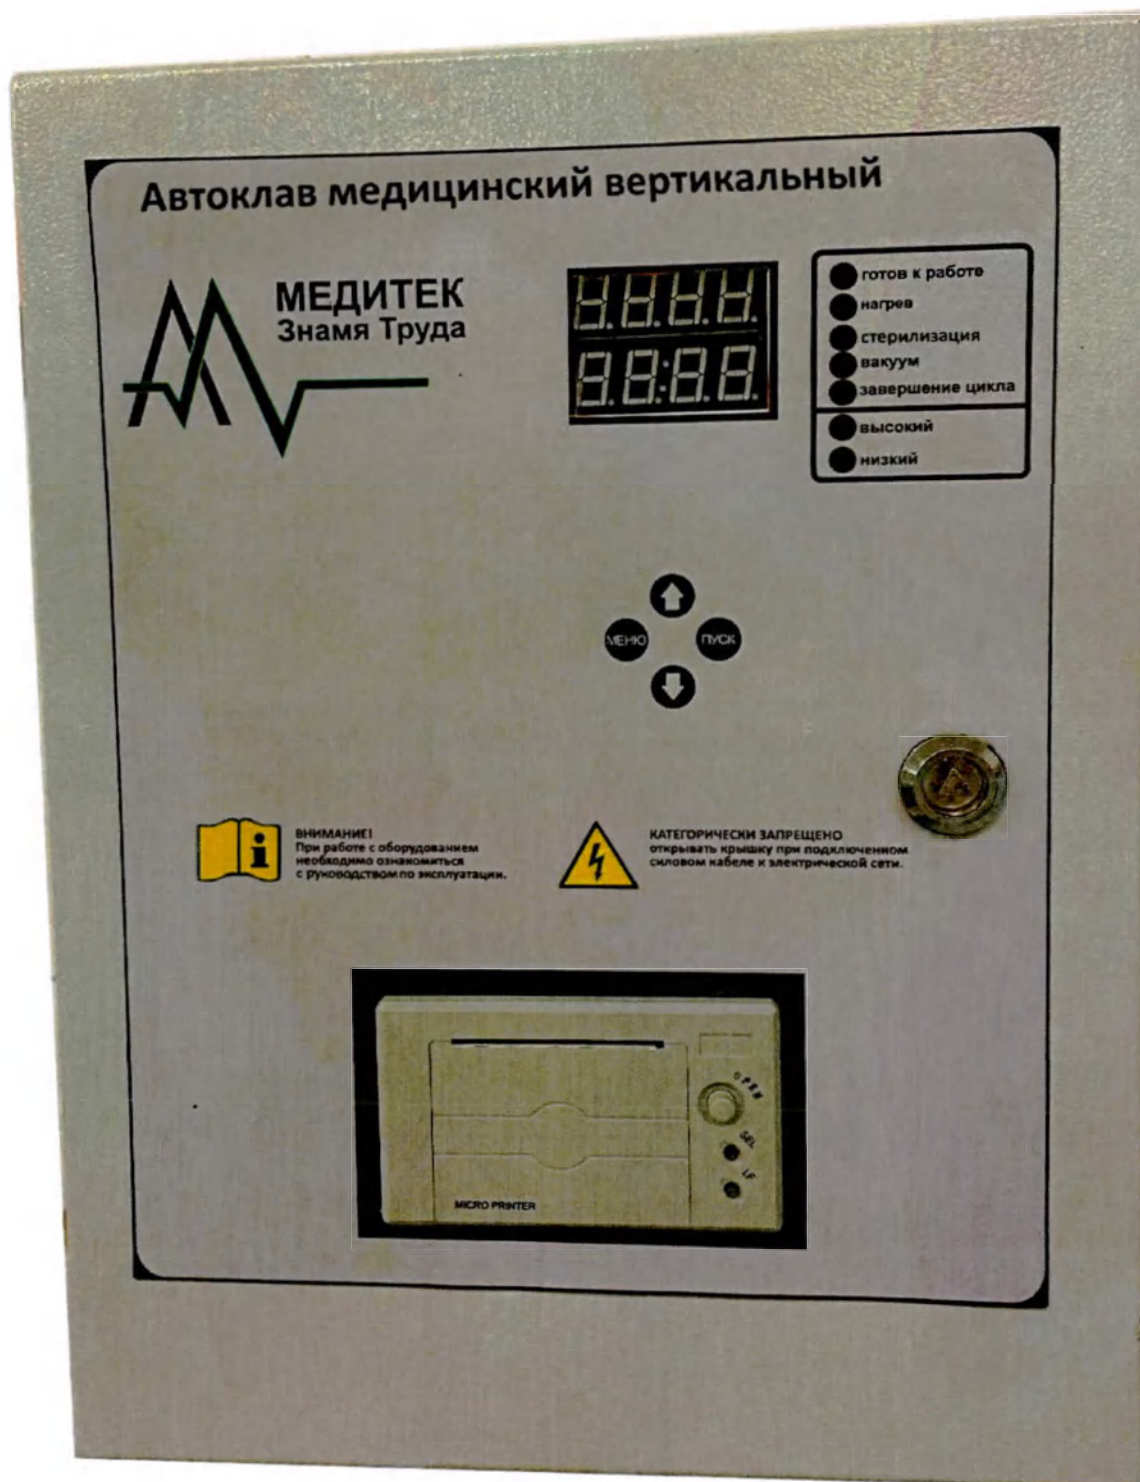

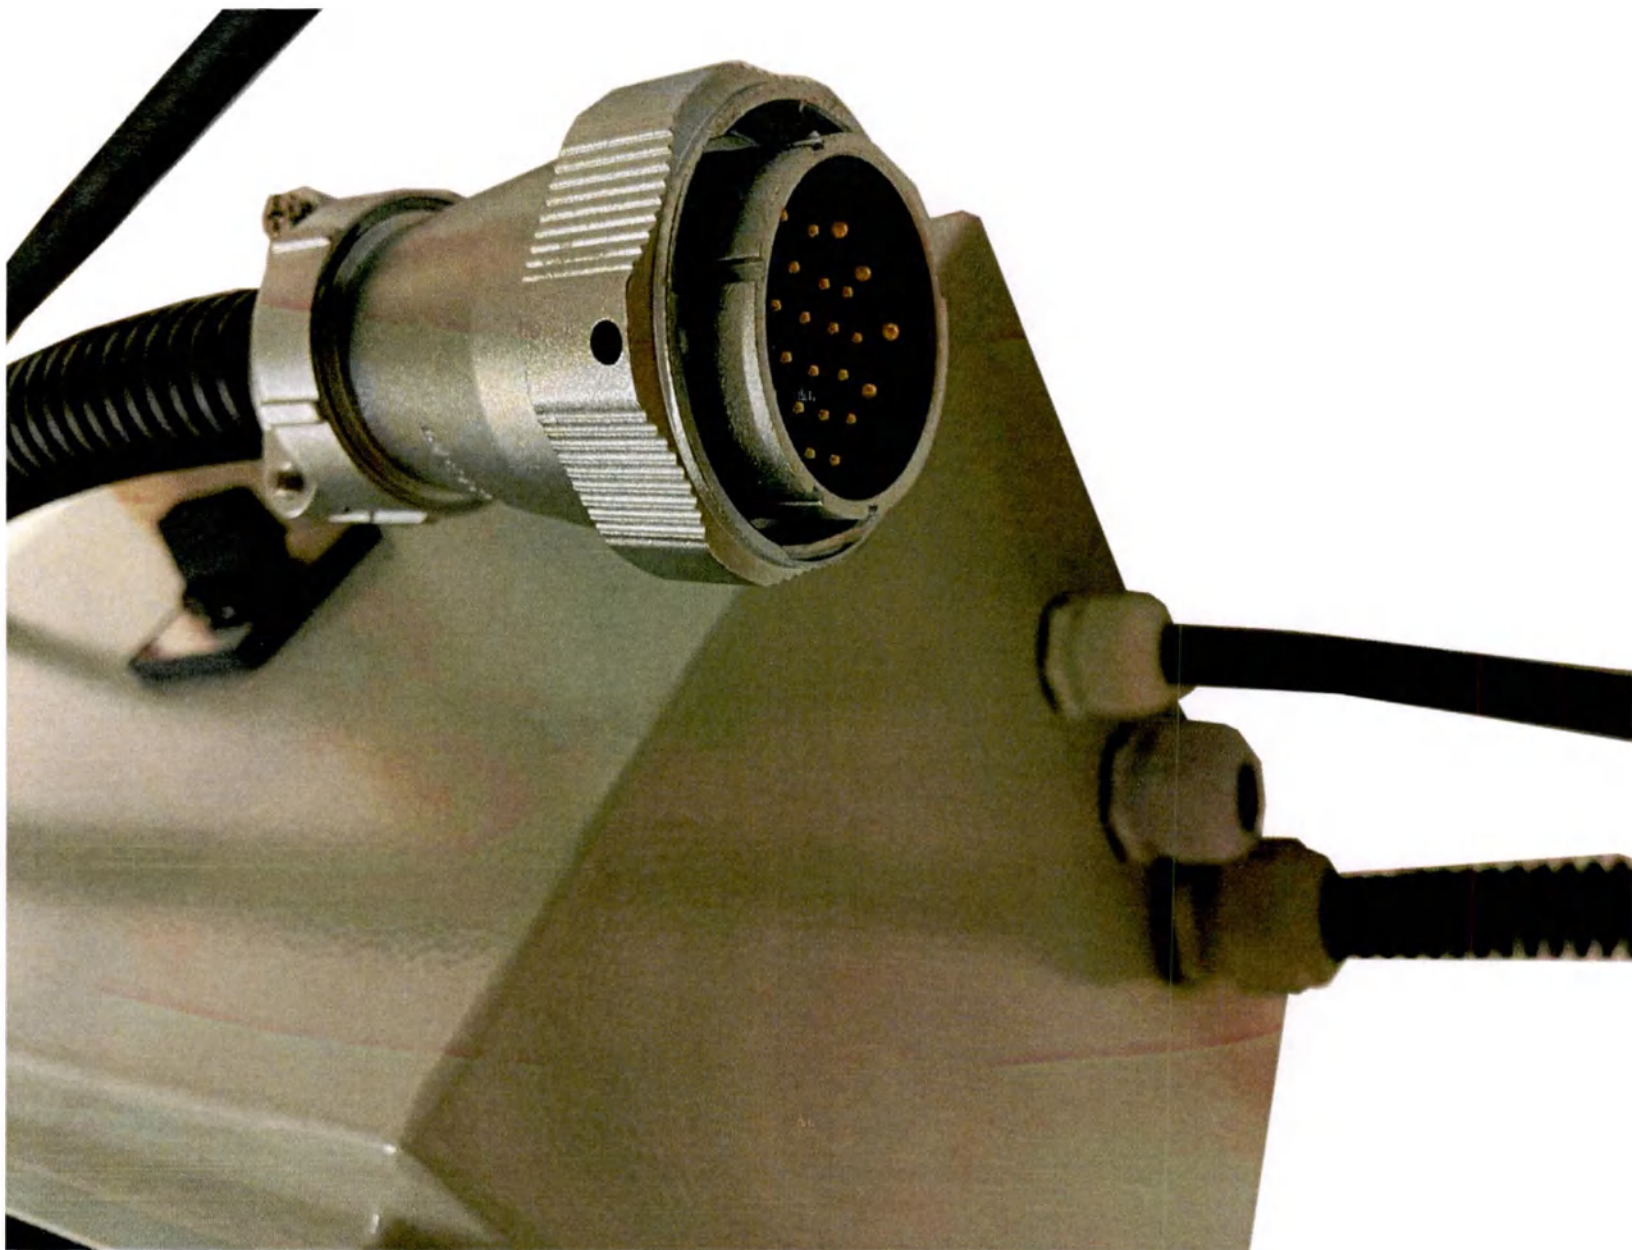

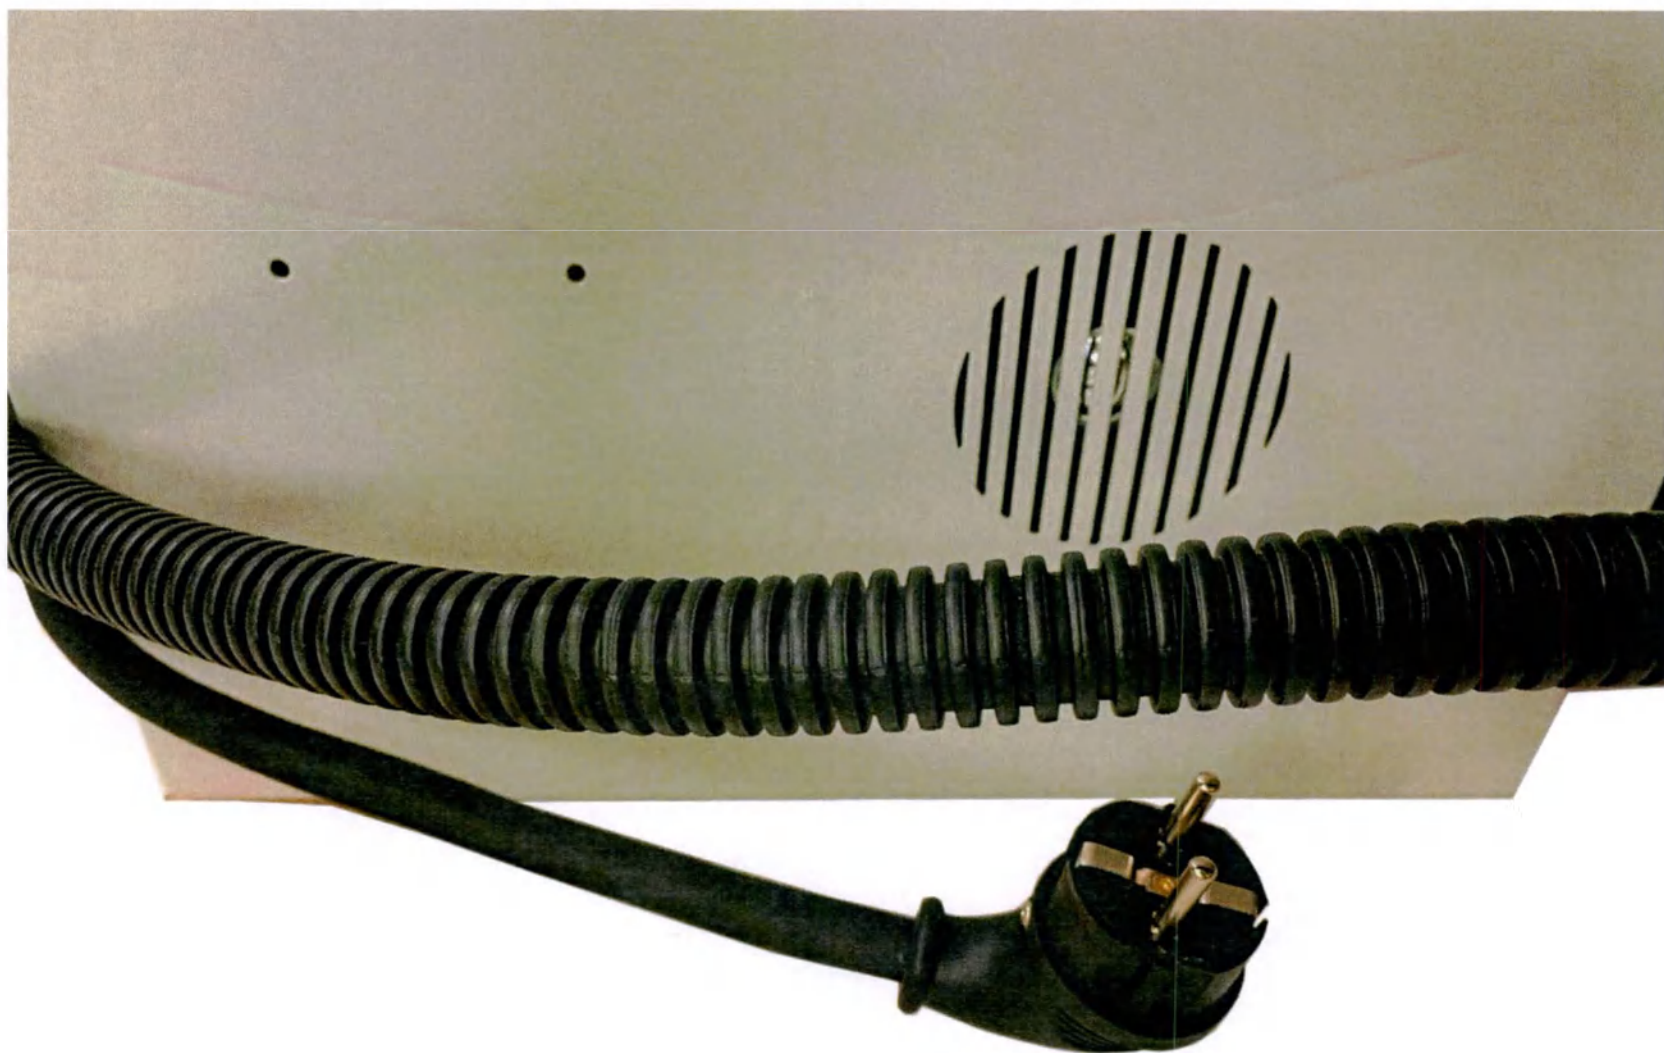


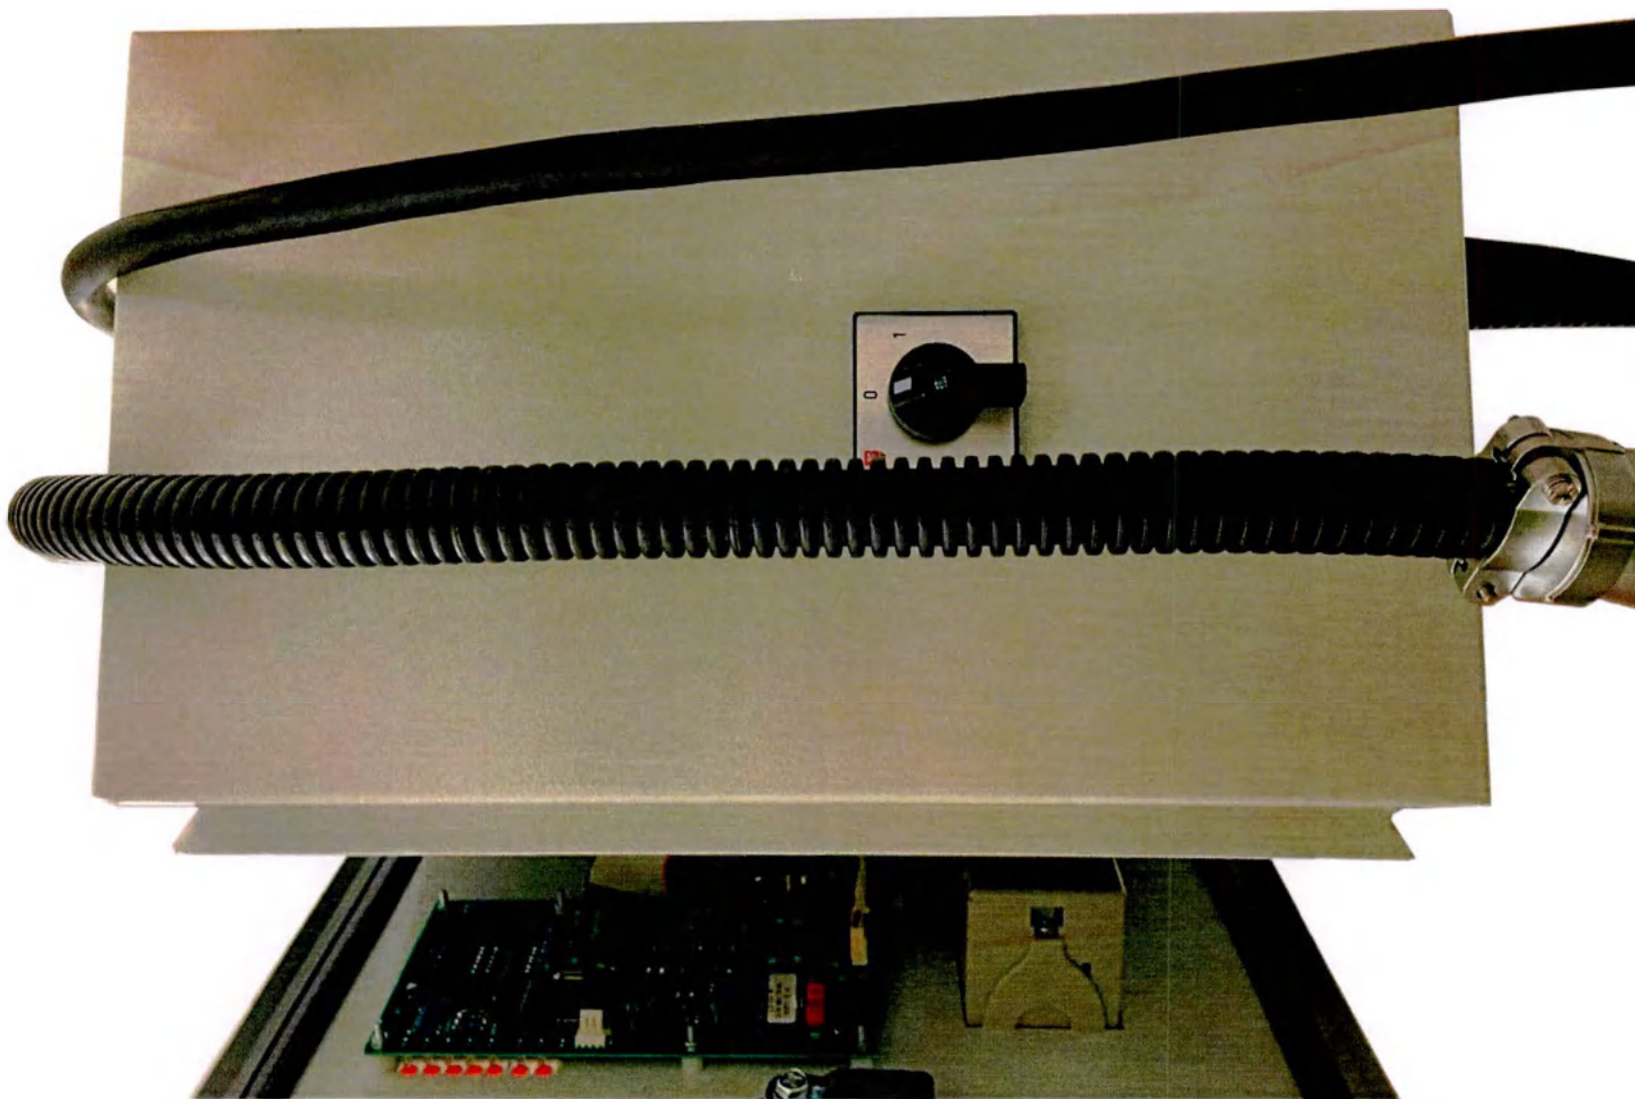

Емкость металлическая с перфорированными поверхностями «БАЛТНЕР® - Ш30 НБ»



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш30 НБ»

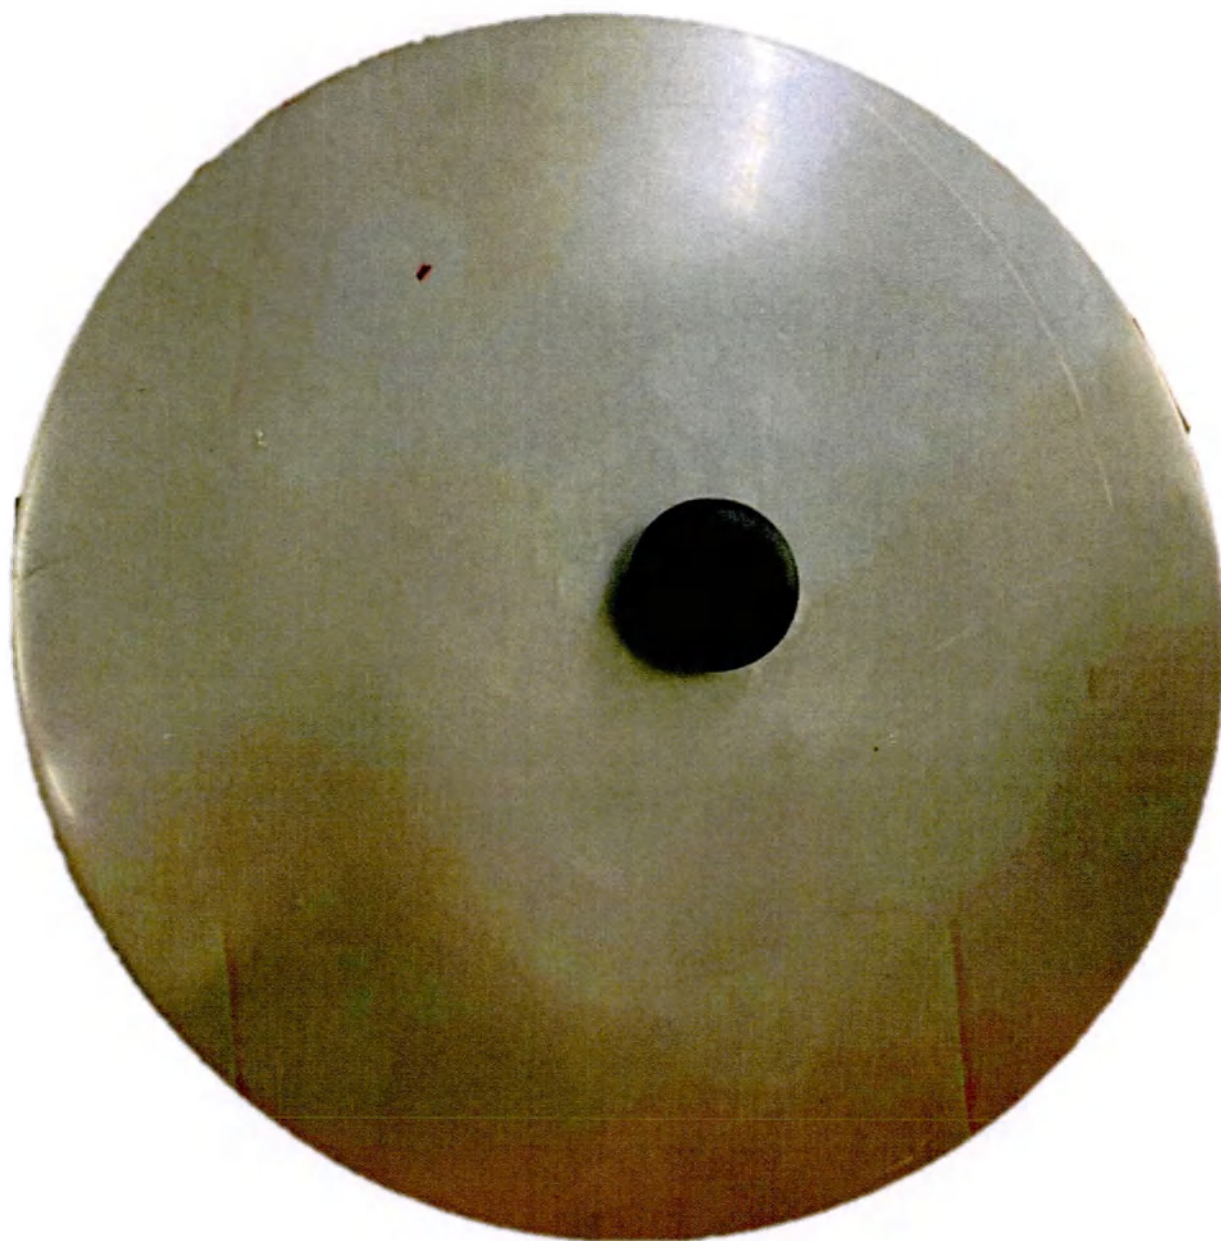

Подставка перфорированная металлическая « БАЛТНЕР® - Ш30 НБ»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



Трубка полимерная металлическая

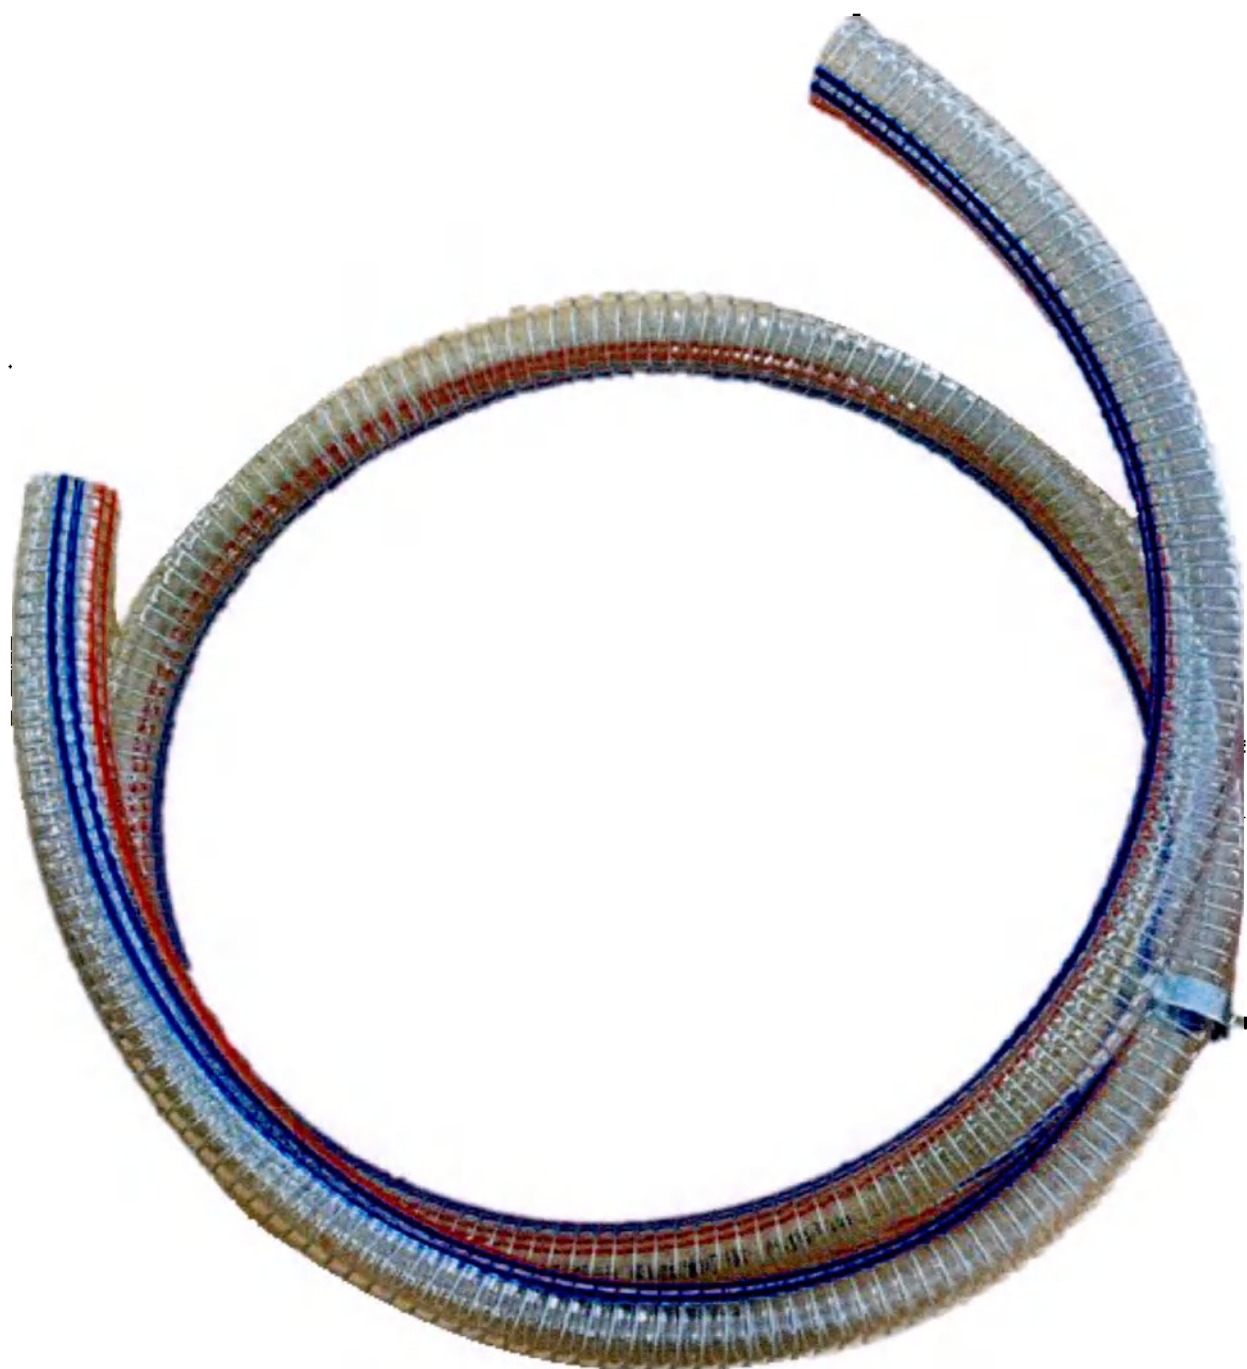

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-30



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-30



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 2,5 кВА

Объем стерилизационной камеры: 30 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00122



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер НБ модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер НБ модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА



07.2023 г.



00122



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских
отходов «БАЛТНЕР® - Ш30 НБ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш30 НБ»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00122

16 Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш50 НБ»

Автоклав модуль 1-50




Камера автоклава модуль 1-50

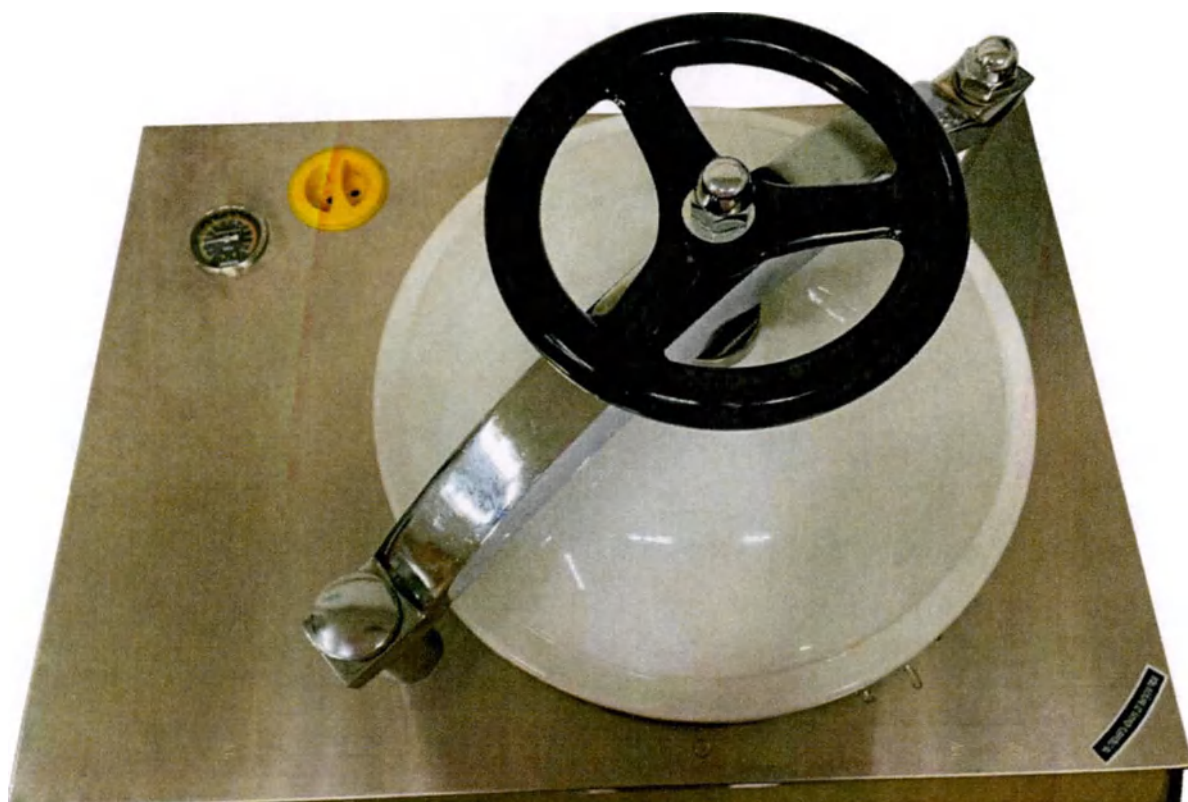









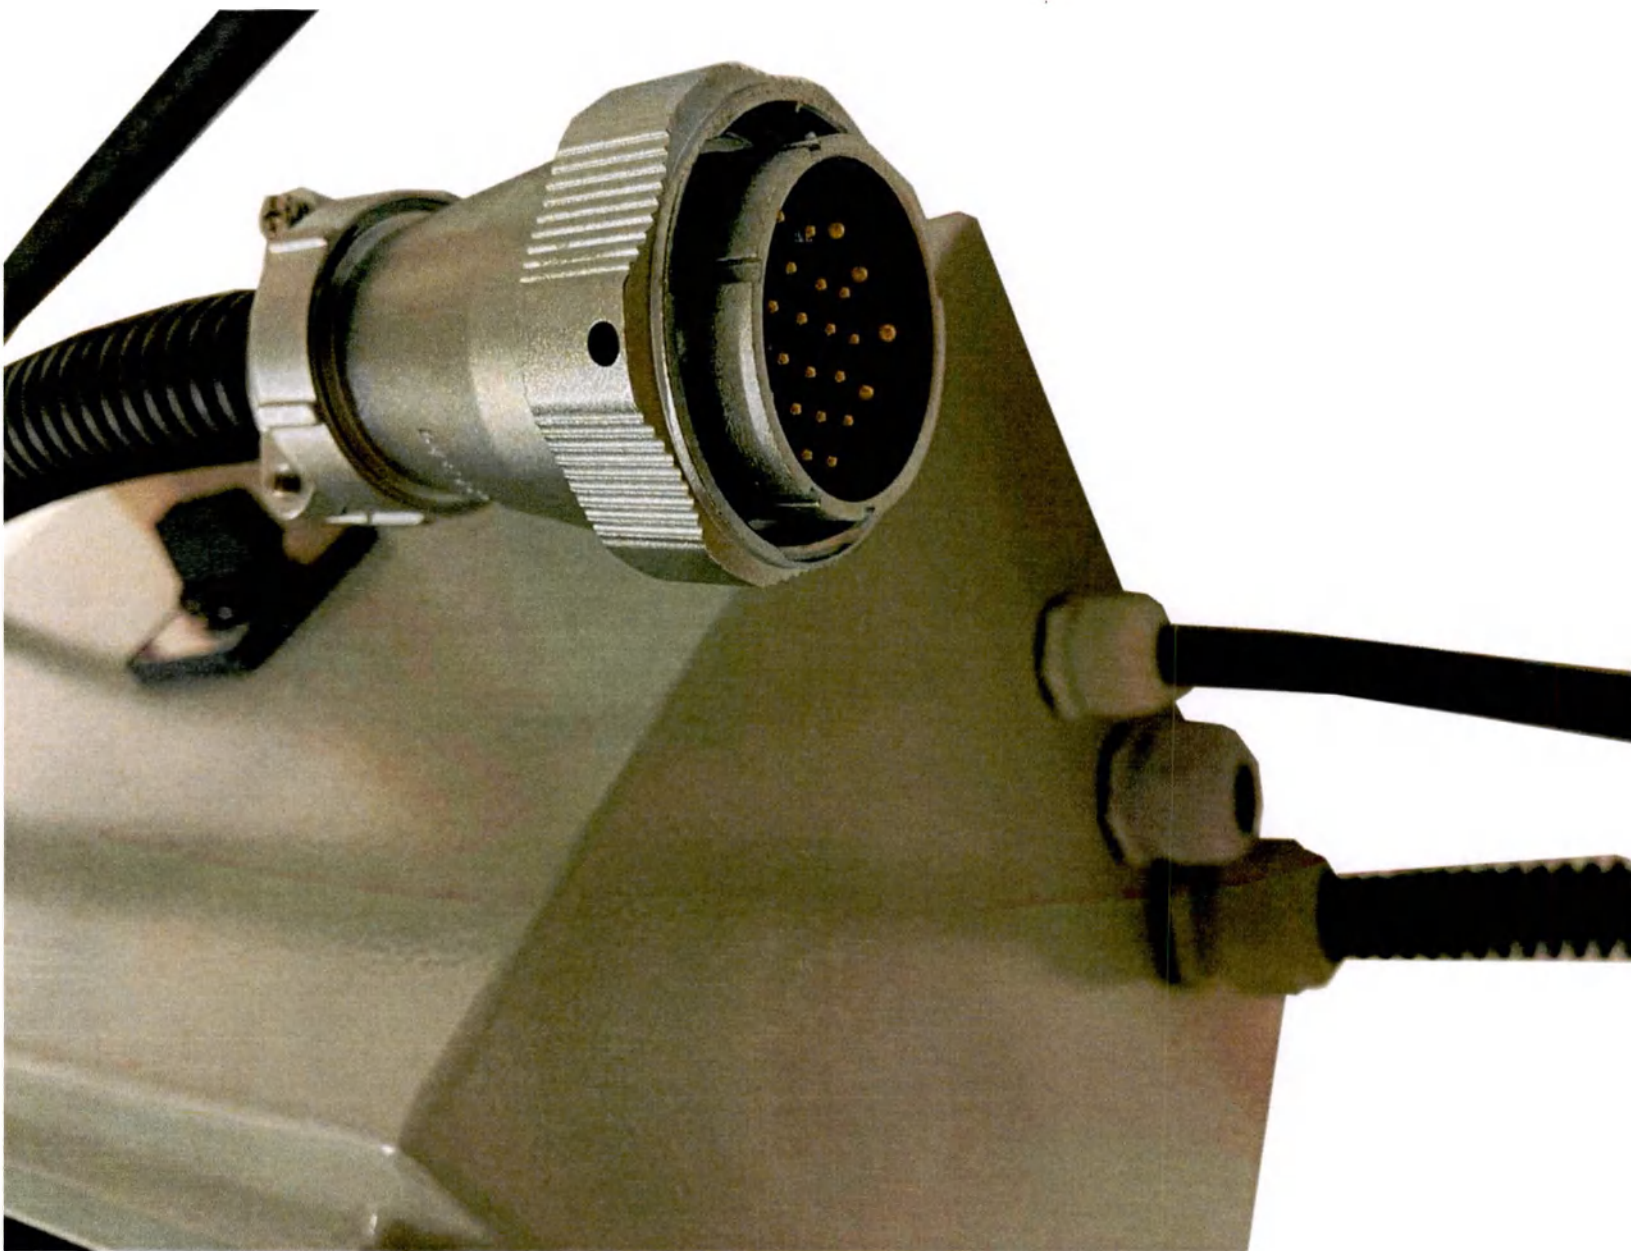


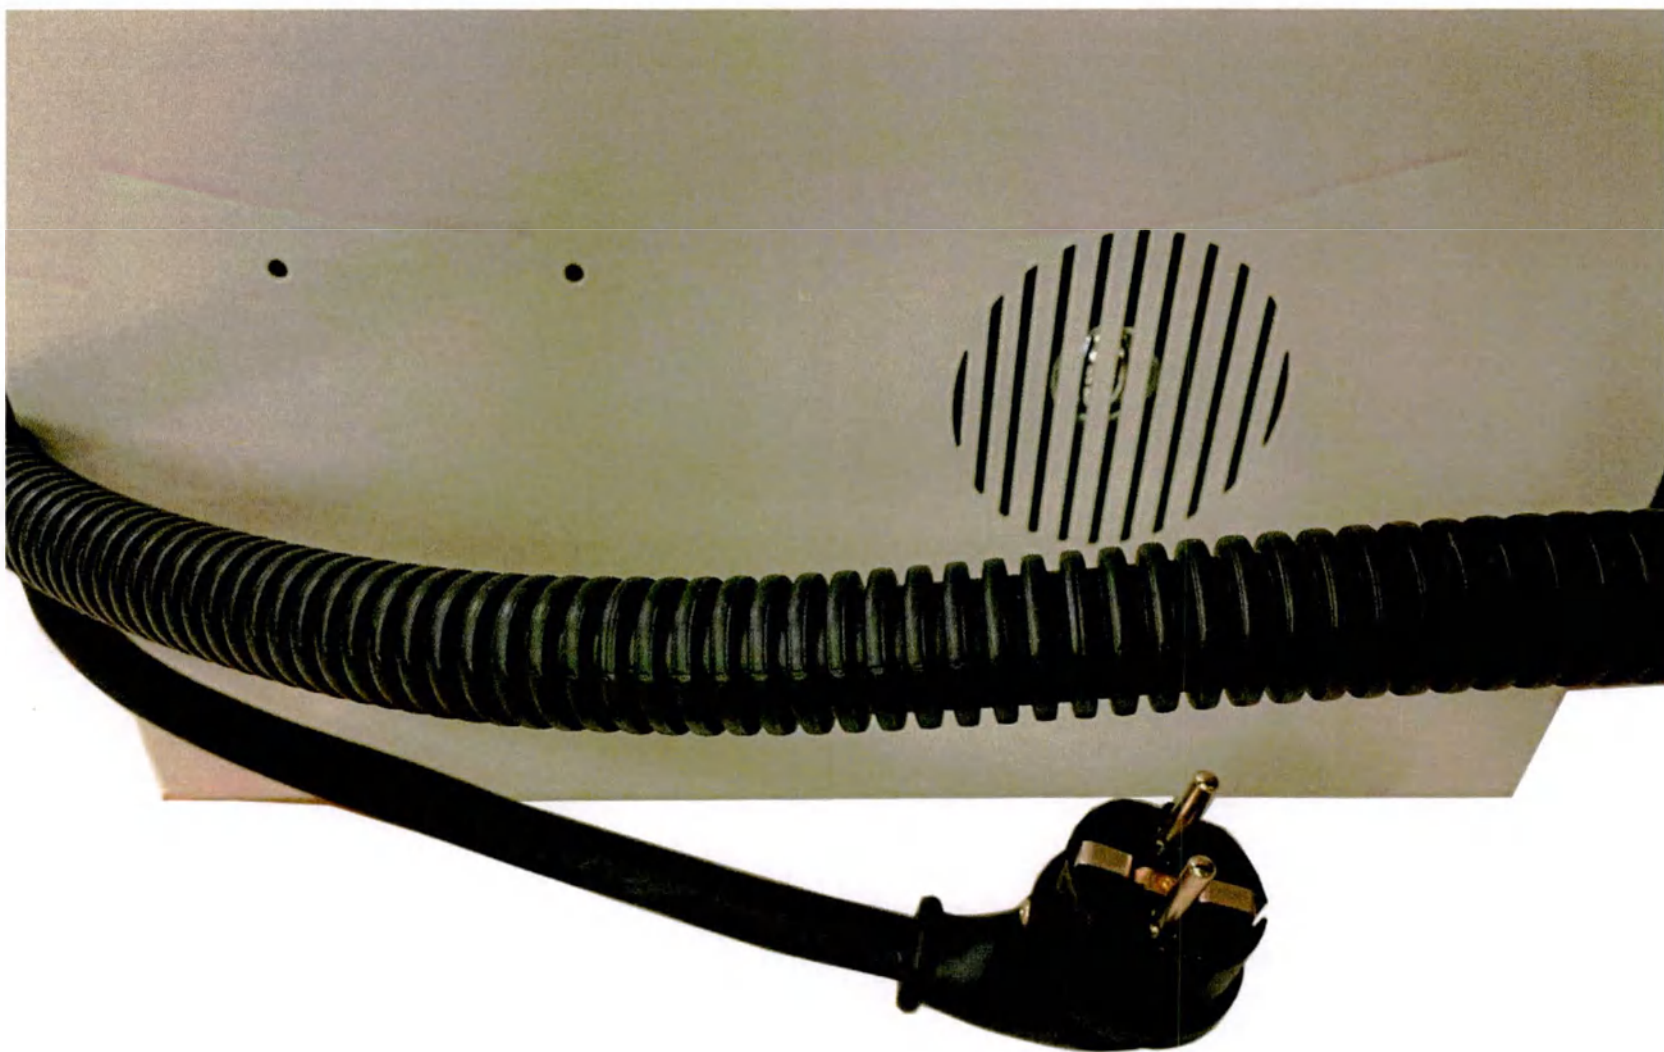

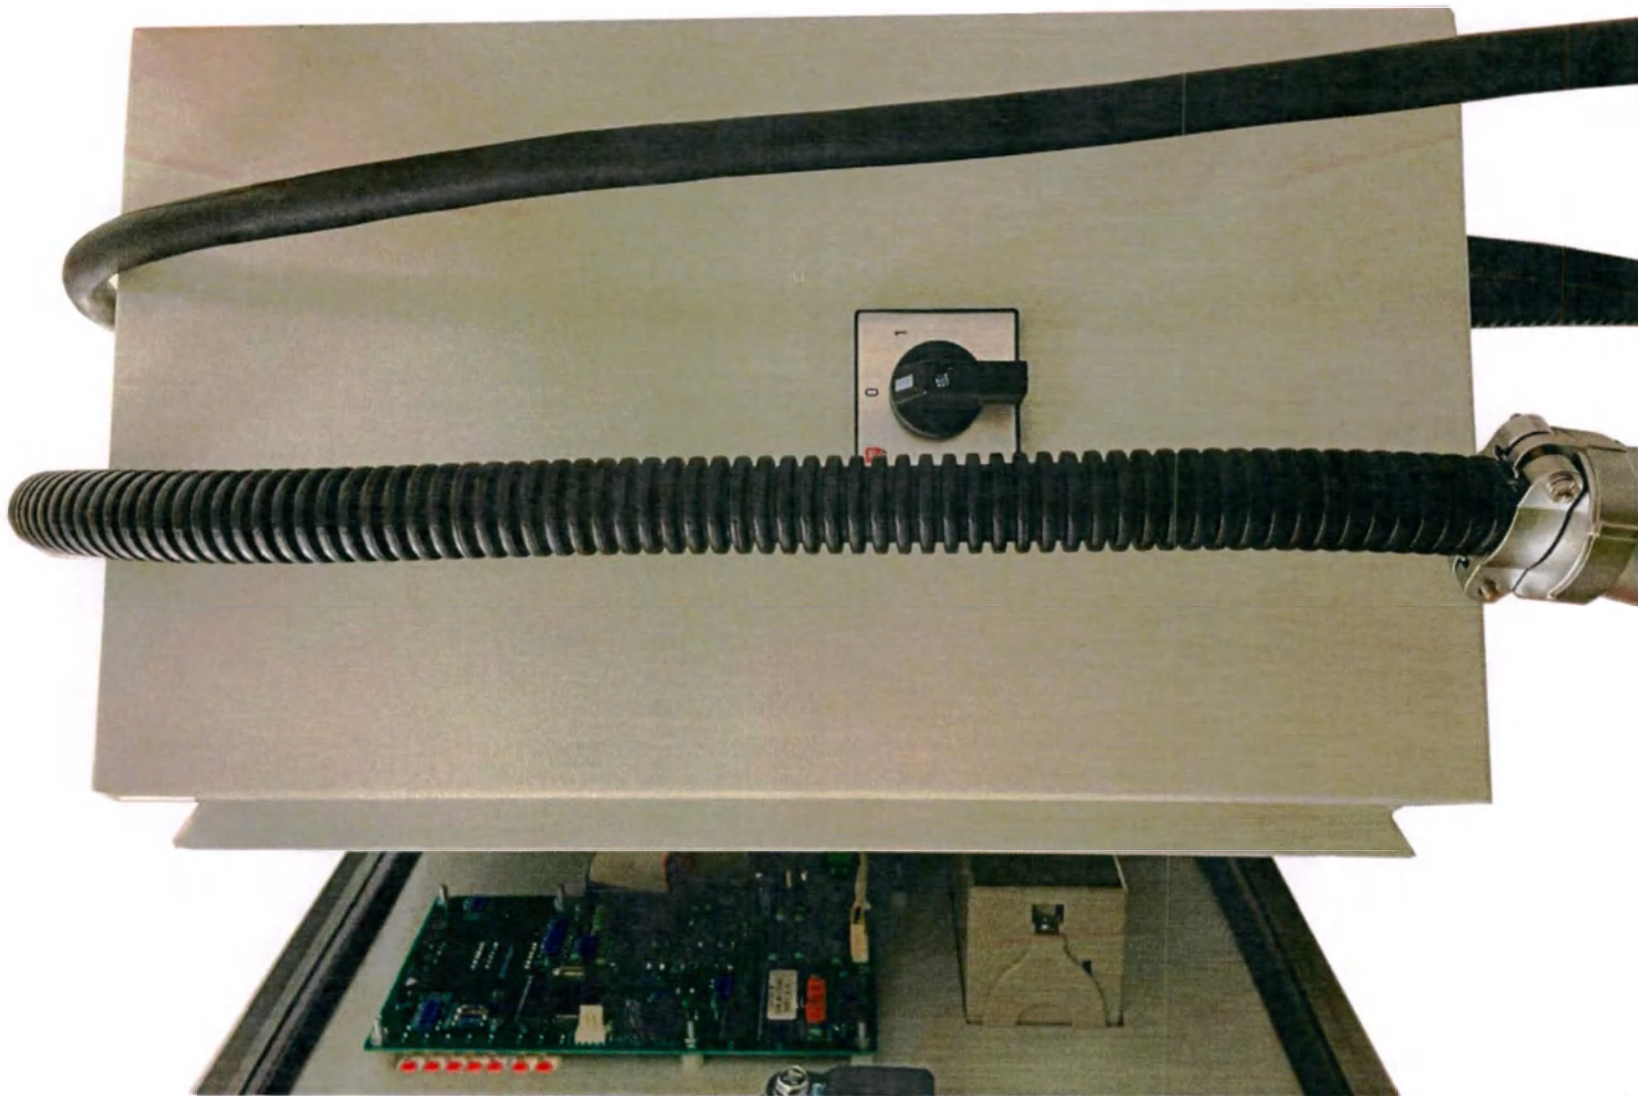



Крышка металлическая « БАЛТНЕР® - Ш50 НБ»

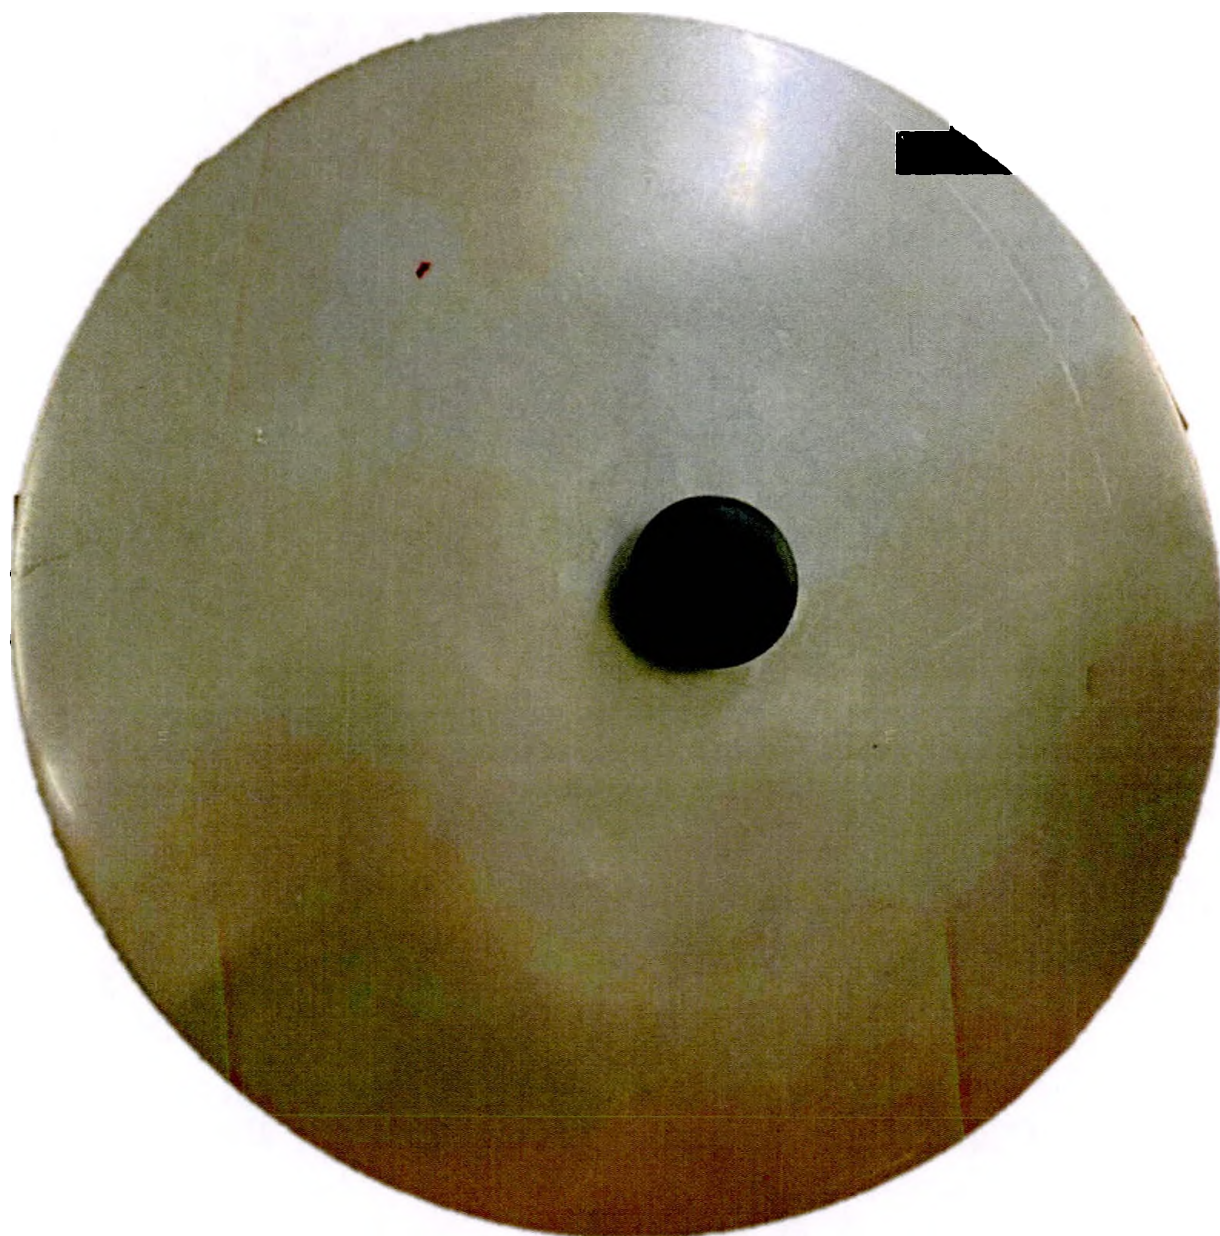

Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш50 Б»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



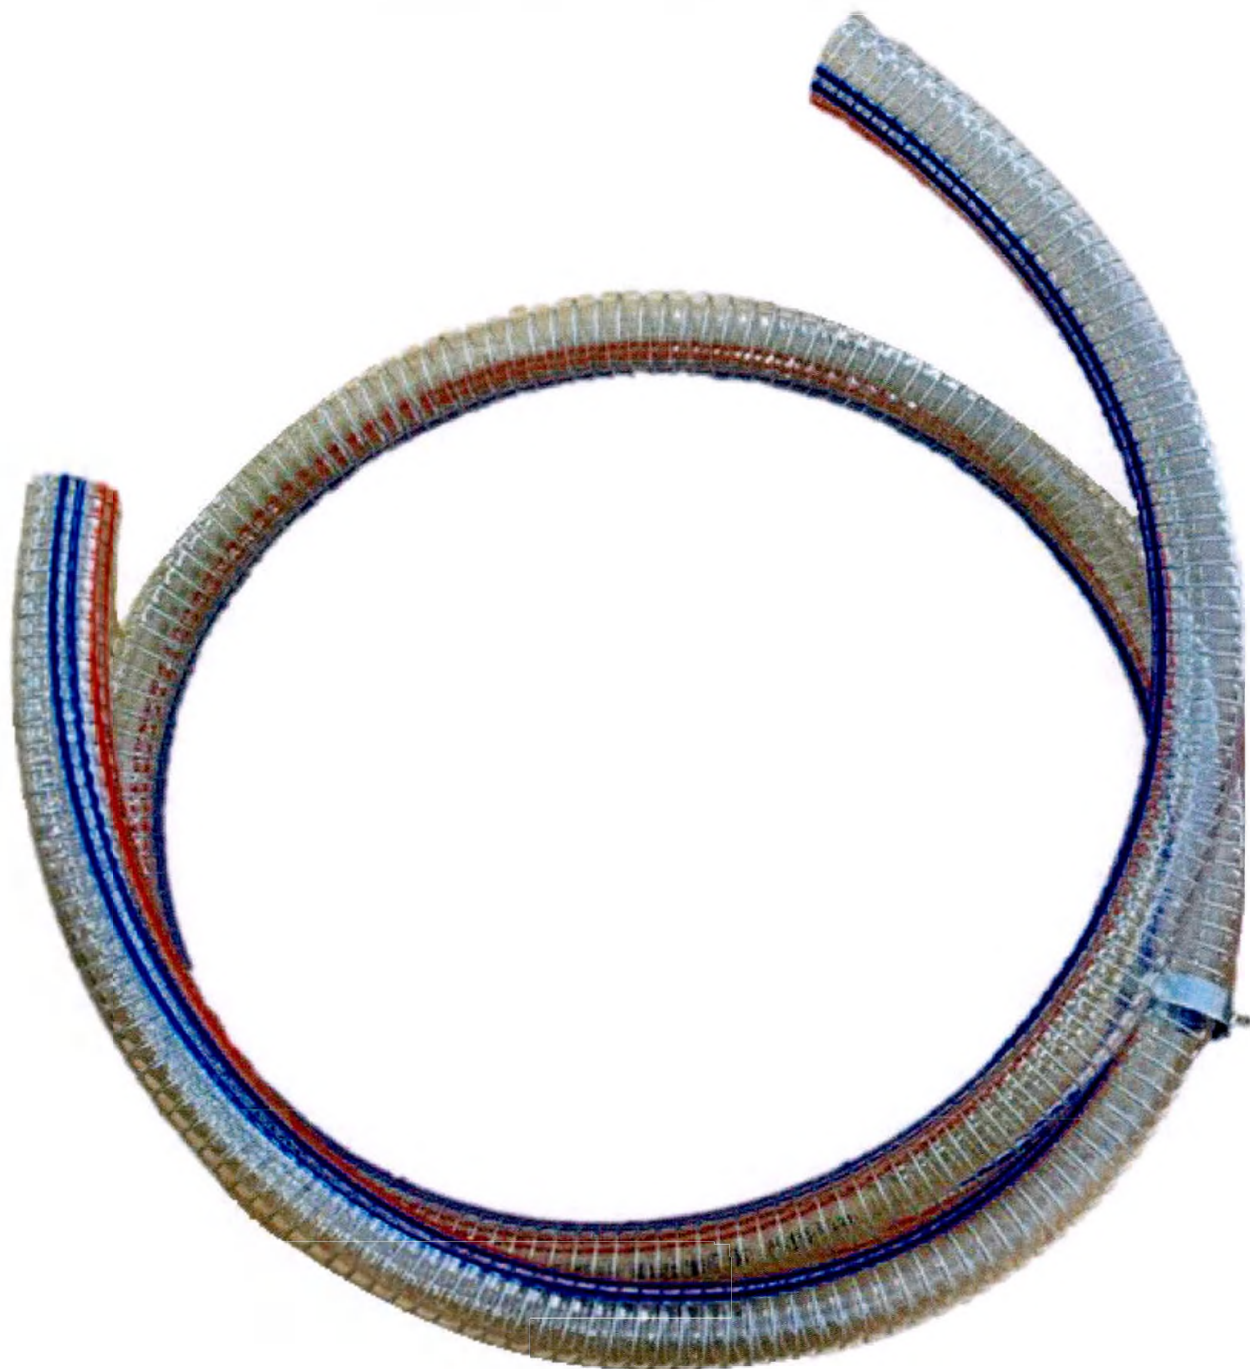

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-50

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Автоклав модуль 1-50

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 3,0 кВА
Объем стерилизационной камеры: 50 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,21 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа

 07.2023 г.
 00123

 РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Шредер НБ модуль 2

МЕДИТЕК®
ЗНАМЯ ТРУДА

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
«БАЛТНЕР® - Ш»
по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023
Шредер НБ модуль 2

 АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»
197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3 ~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА

 07.2023 г.
 00123

 РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш50 НБ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш50 НБ»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.

SN


00123


17. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш100 НБ»

Автоклав модуль 1-100




Камера автоклава модуль 1-100

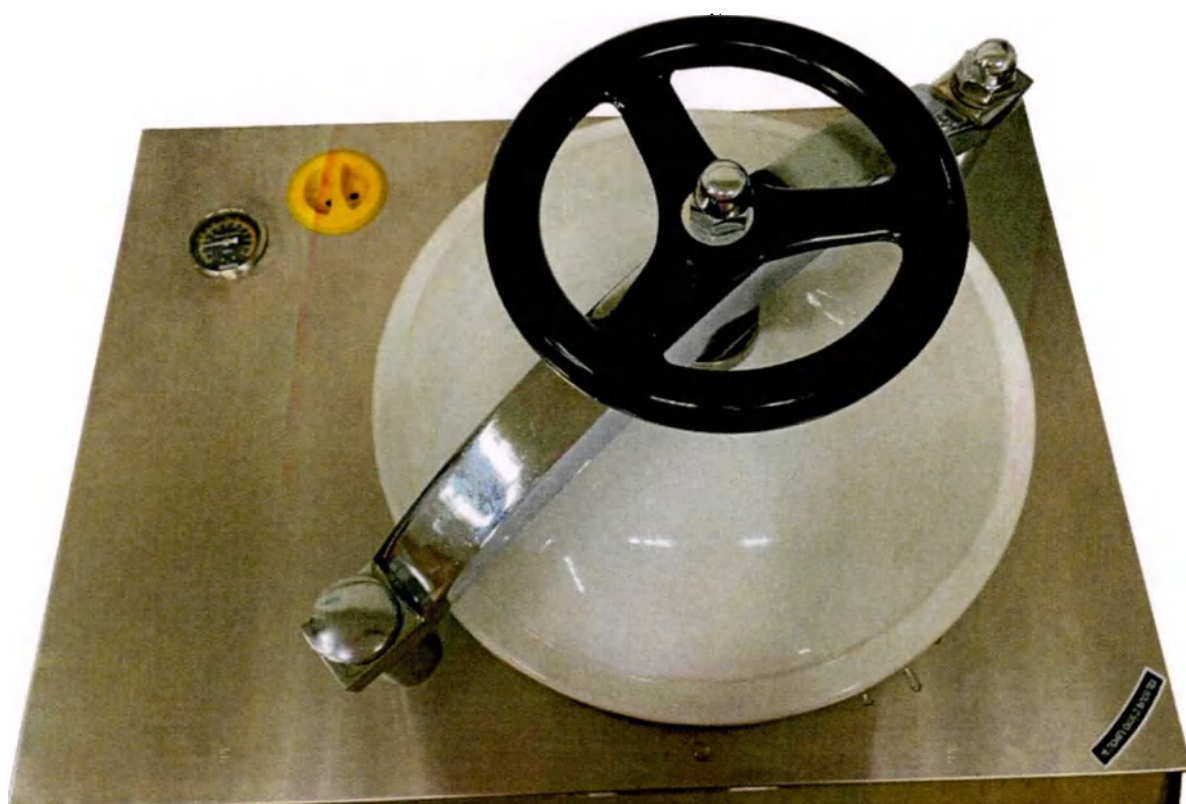


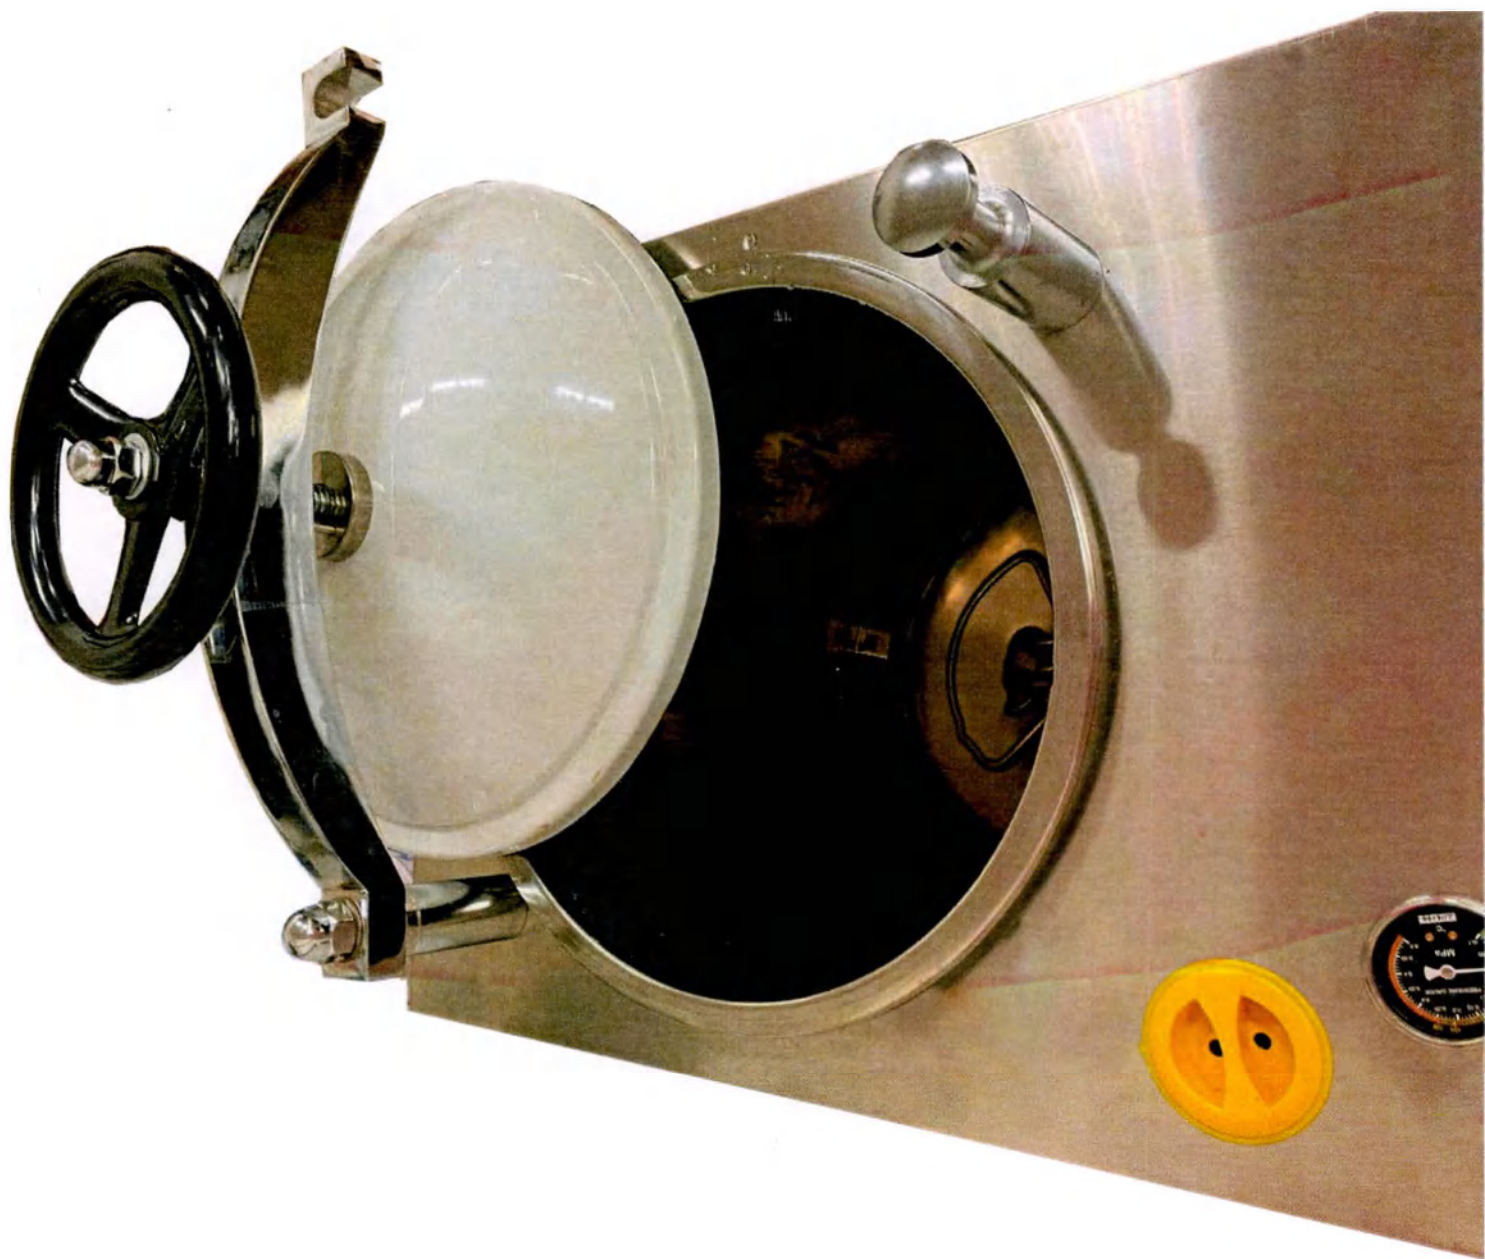



Шредер НБ модуль 2



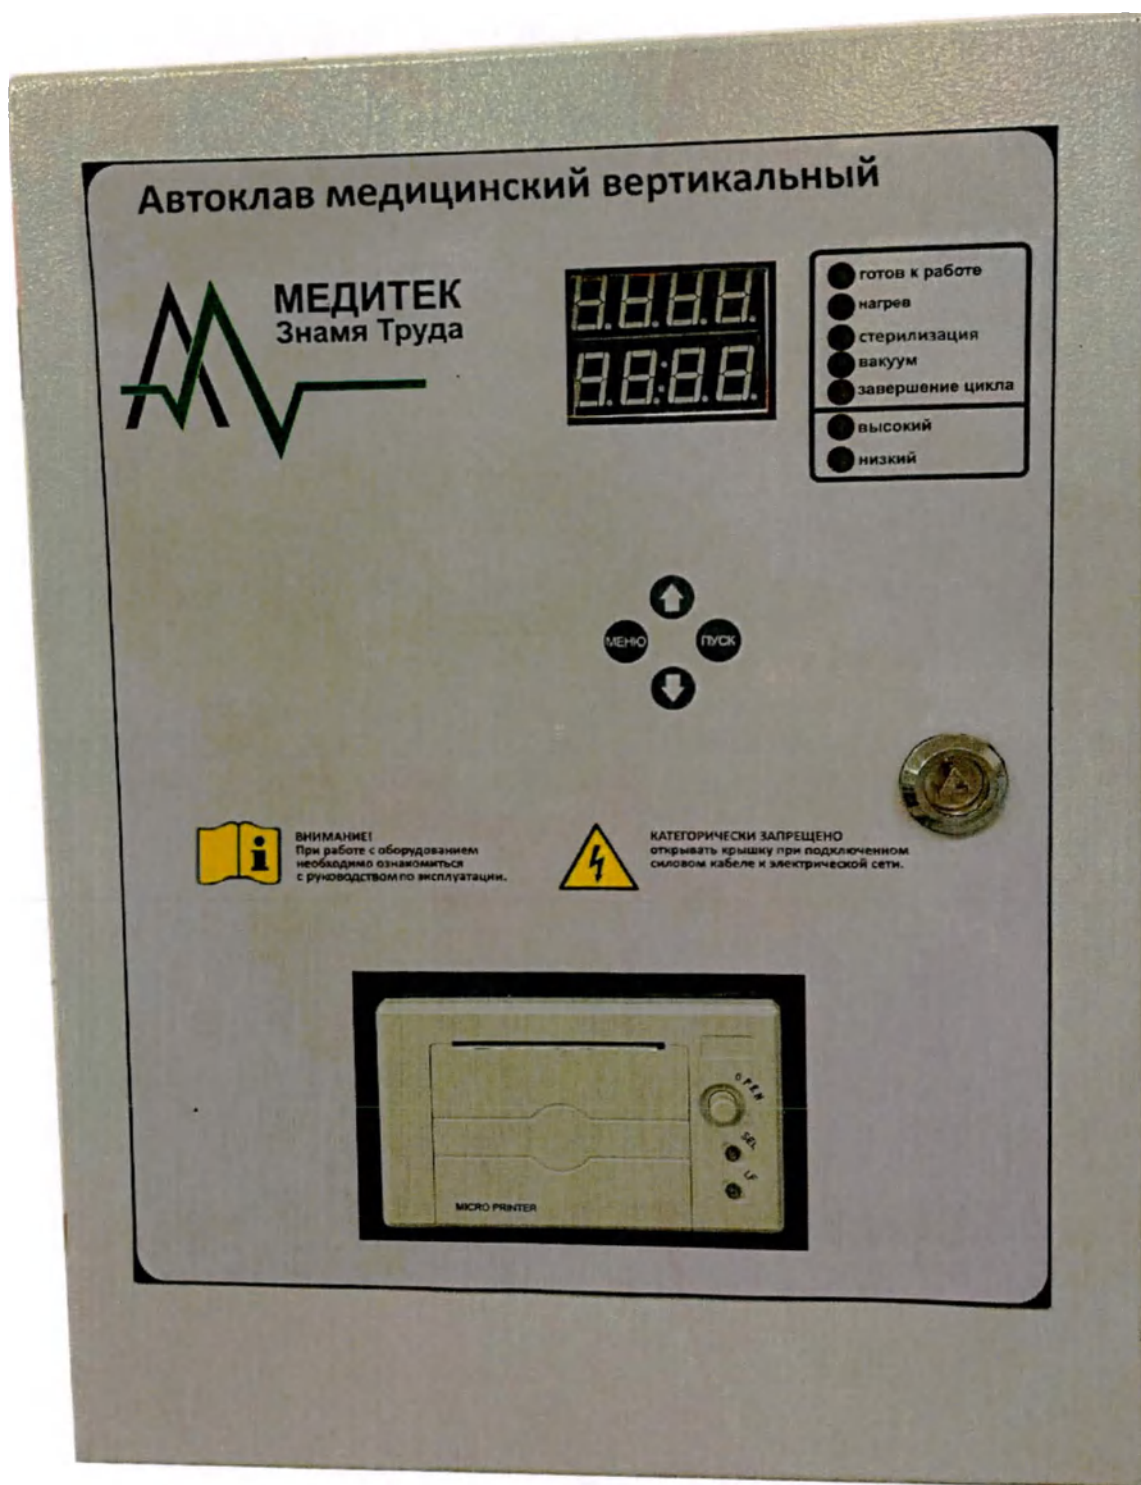

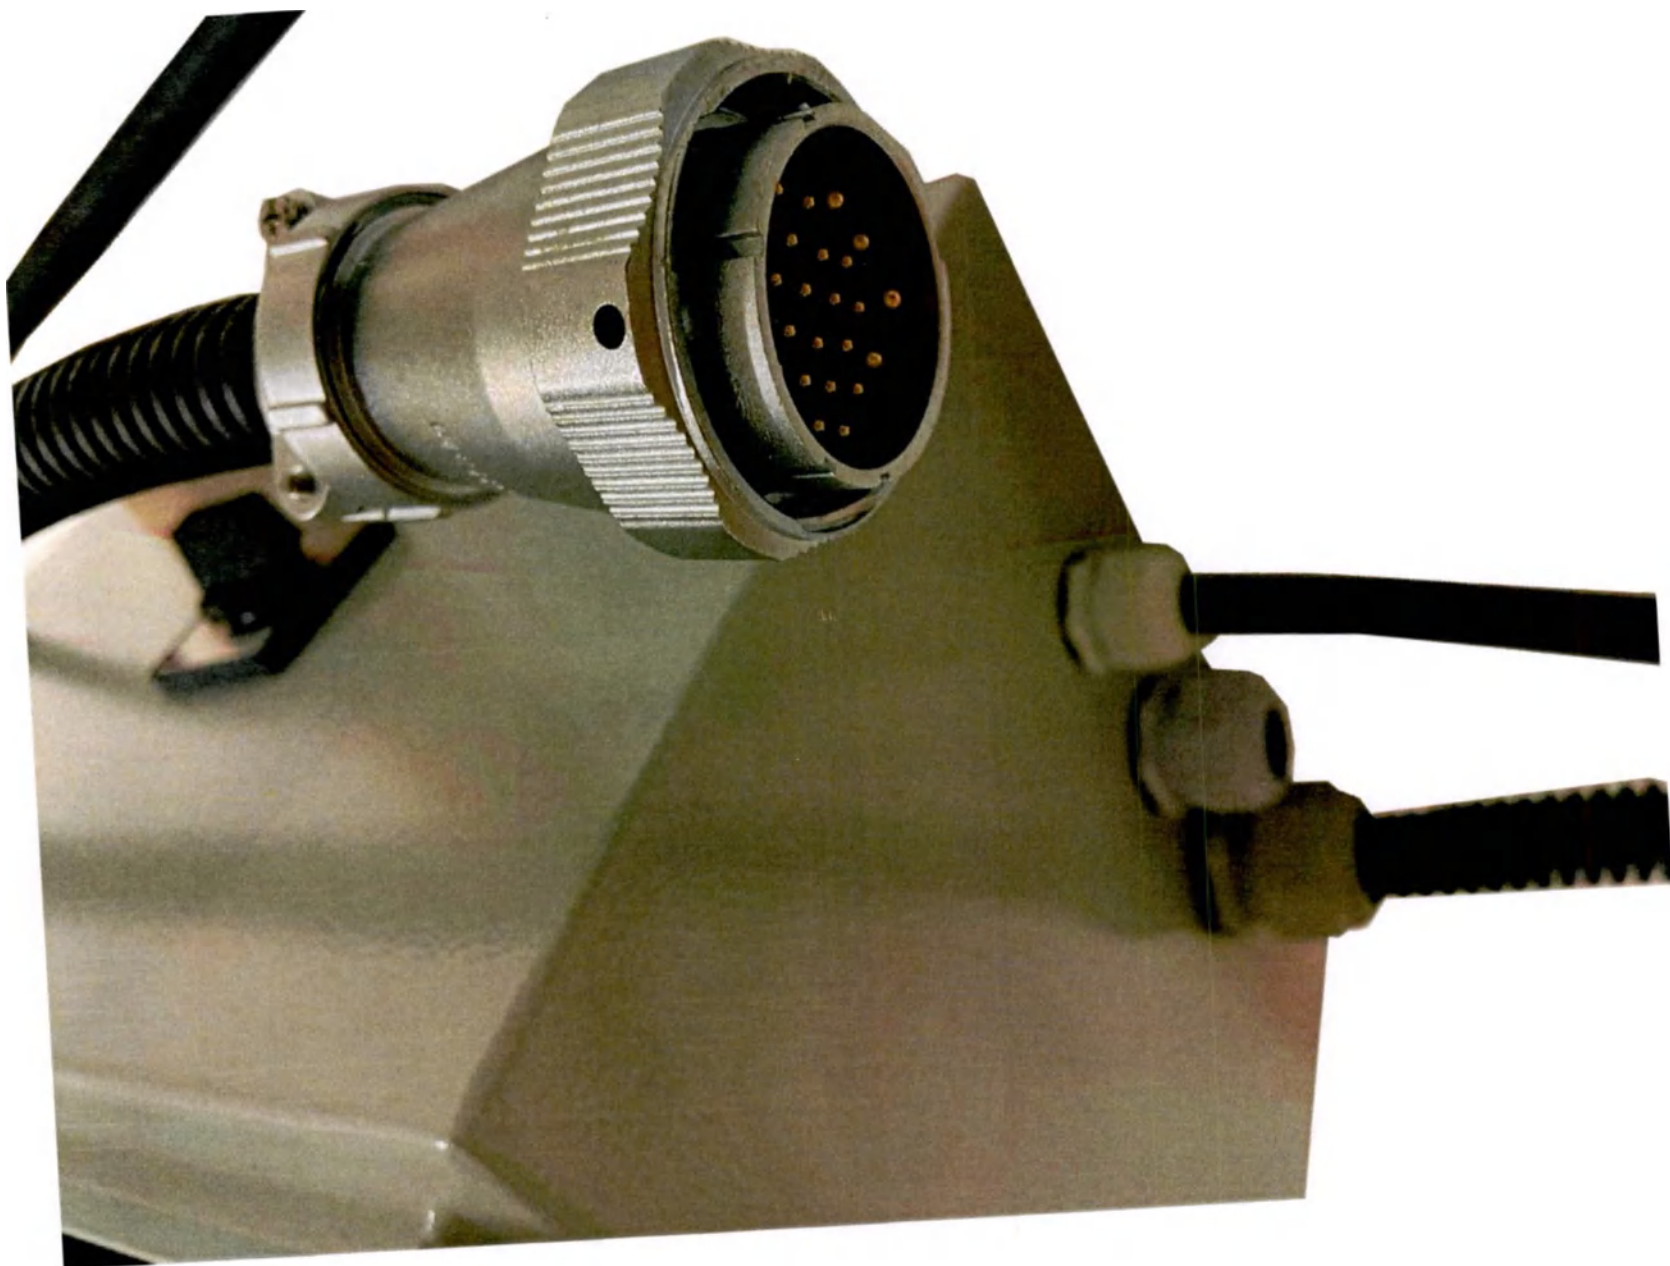

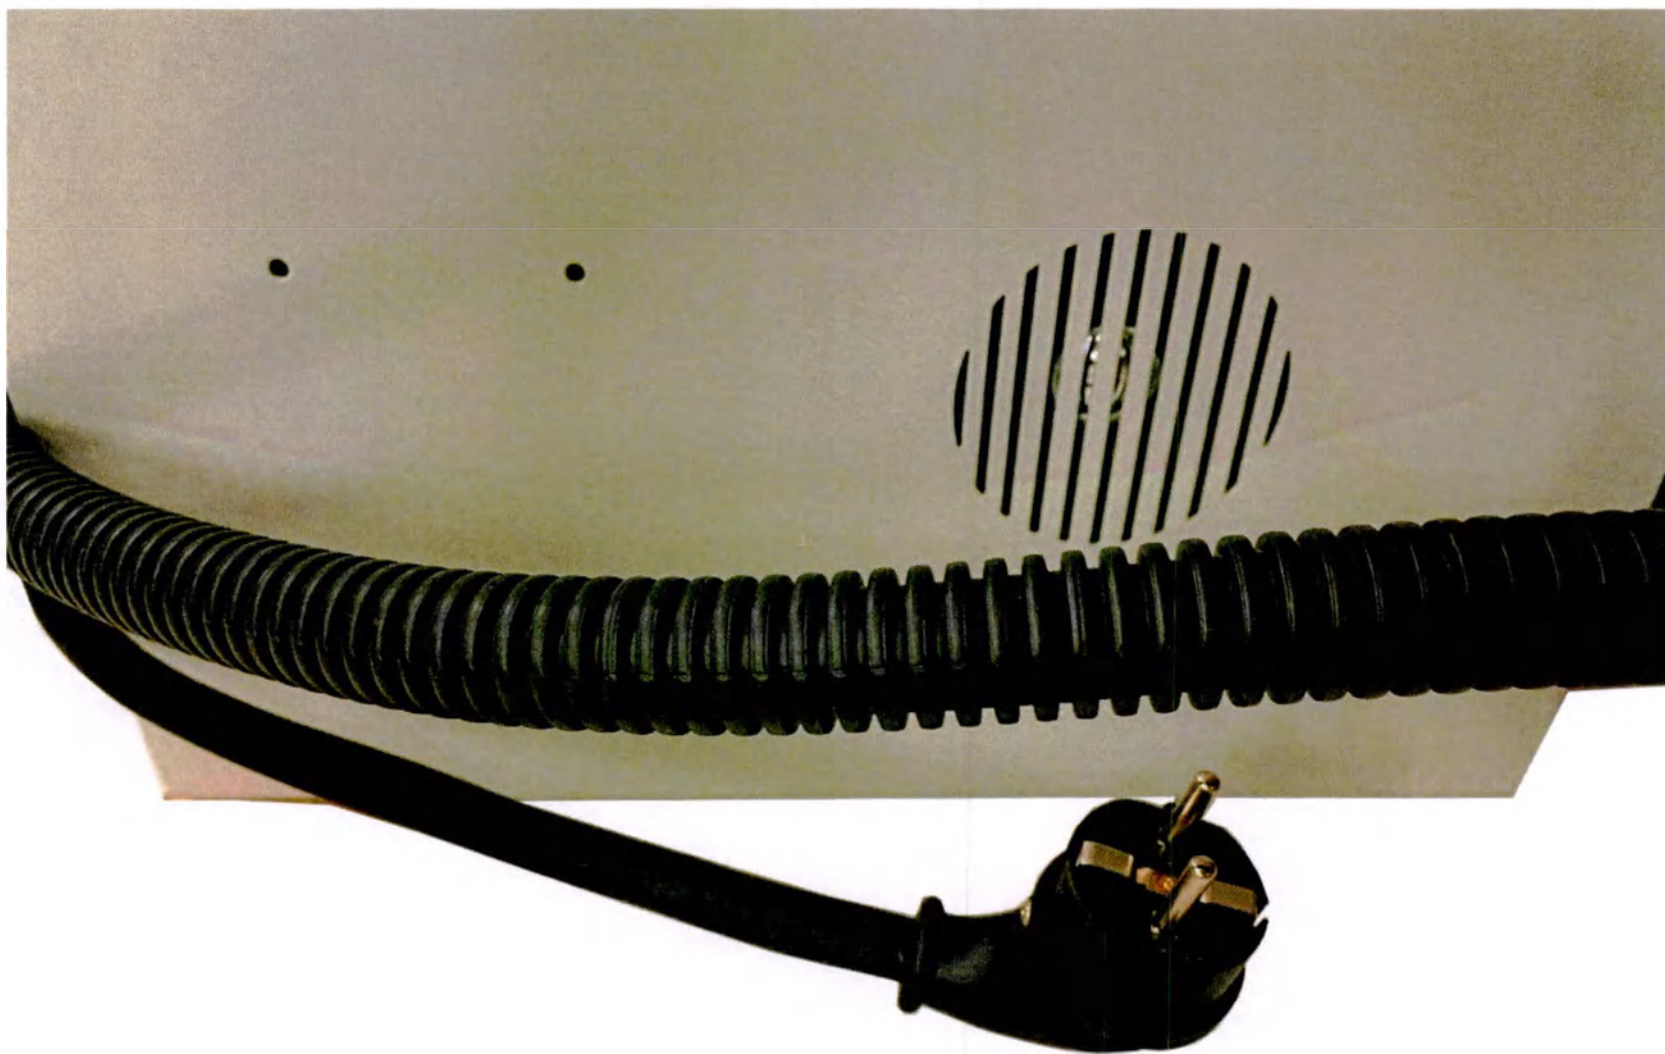

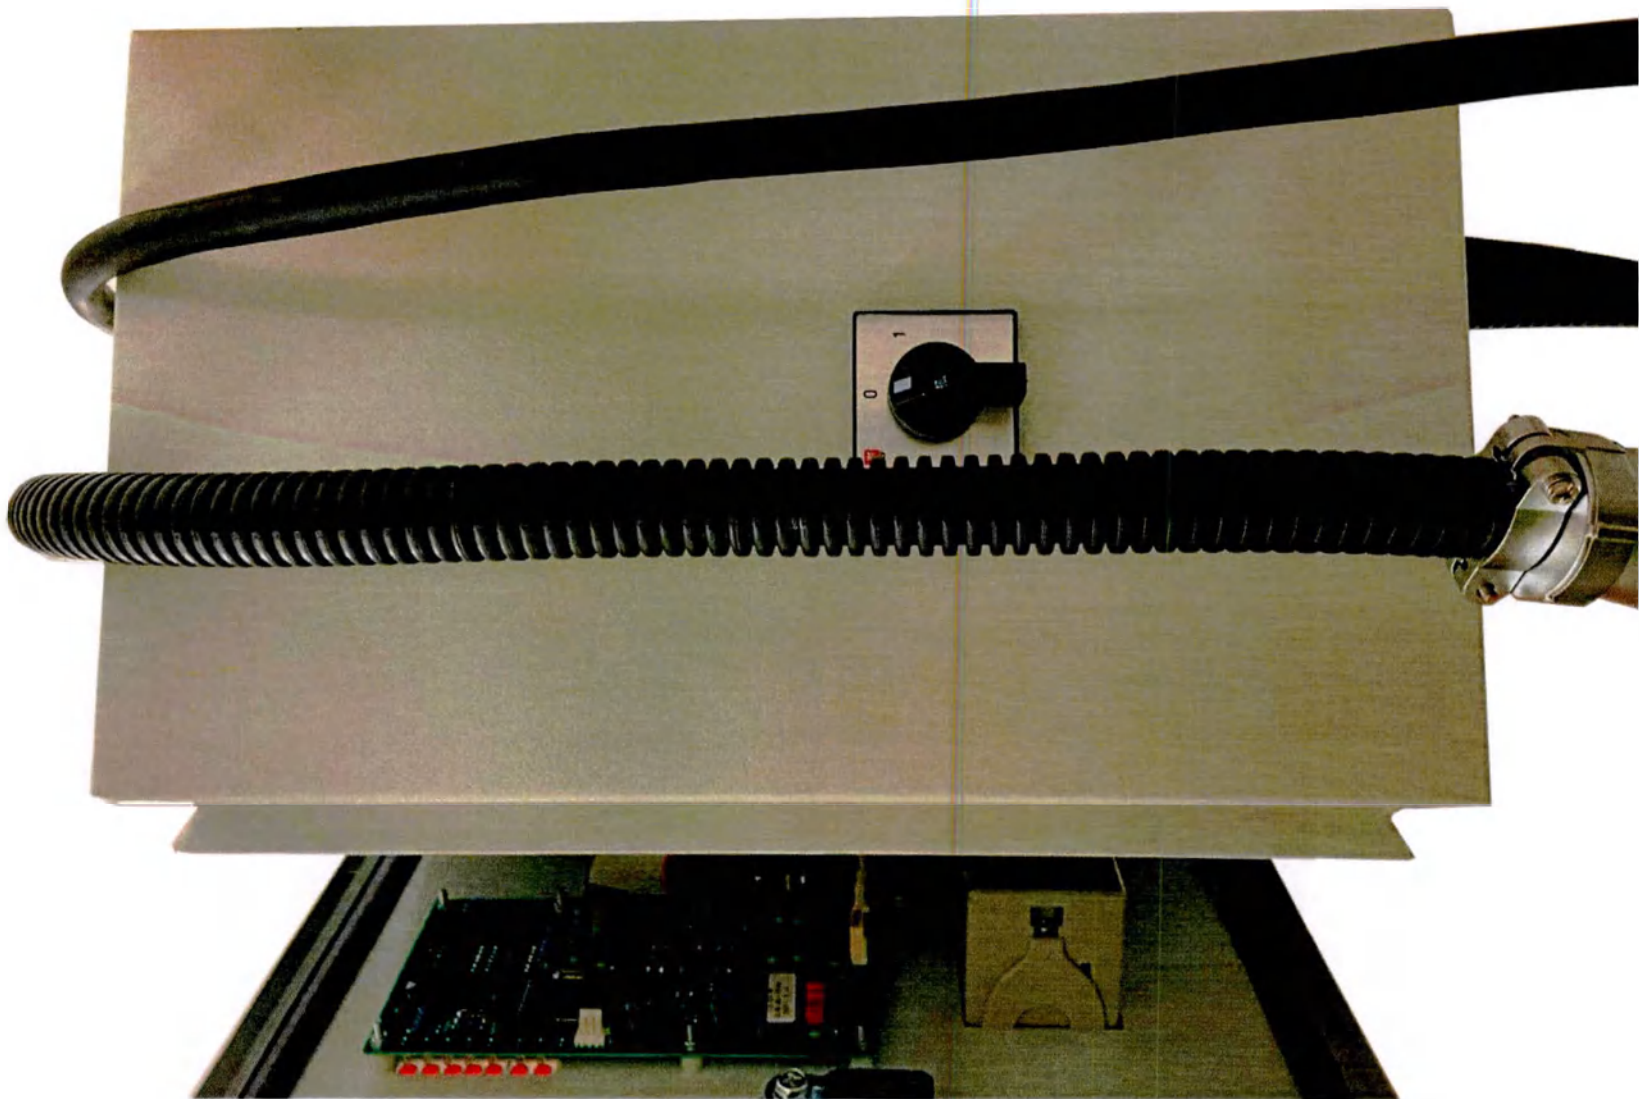



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 НБ»




Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш100 Б»





Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



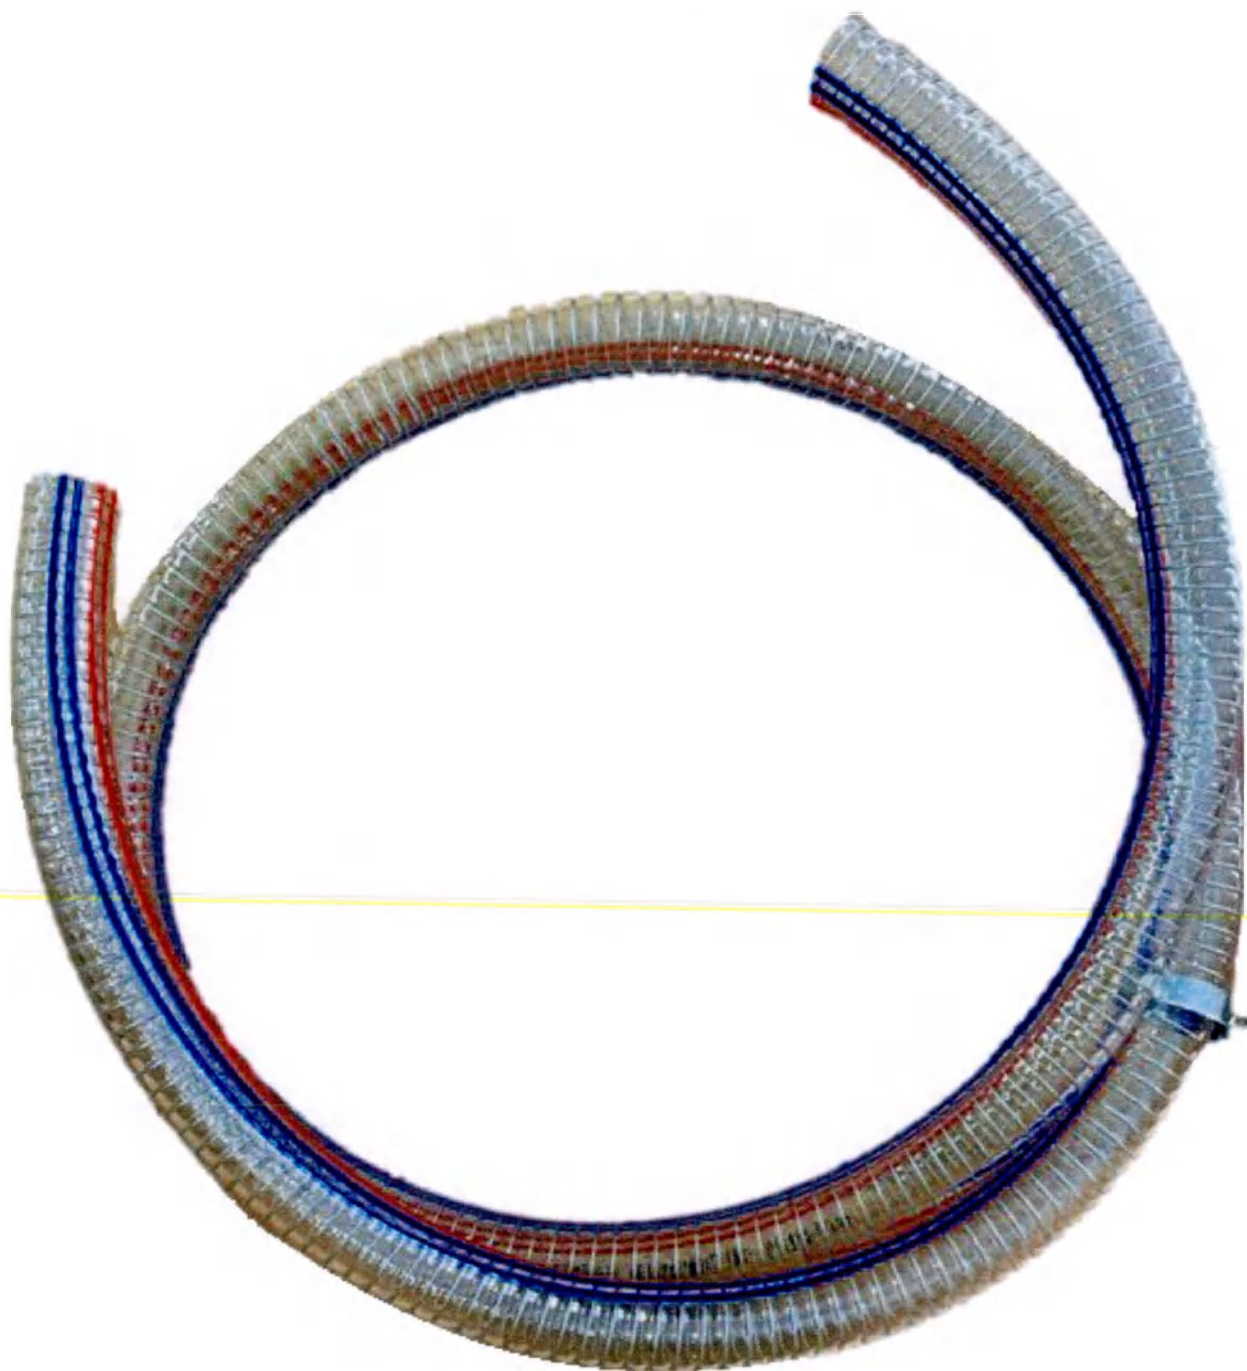

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклава модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00124



ПУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Шредер НБ модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер НБ модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Питание шредера: 380 В, 3~50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВт



07.2023 г.



00124



ПУ: № _____ / _____ от _____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш100 НБ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш100 НБ»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.



00124

18. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш200 НБ»

Автоклав модуль 1-100




Автоклав модуль 1-100




Камера автоклава модуль 1-100




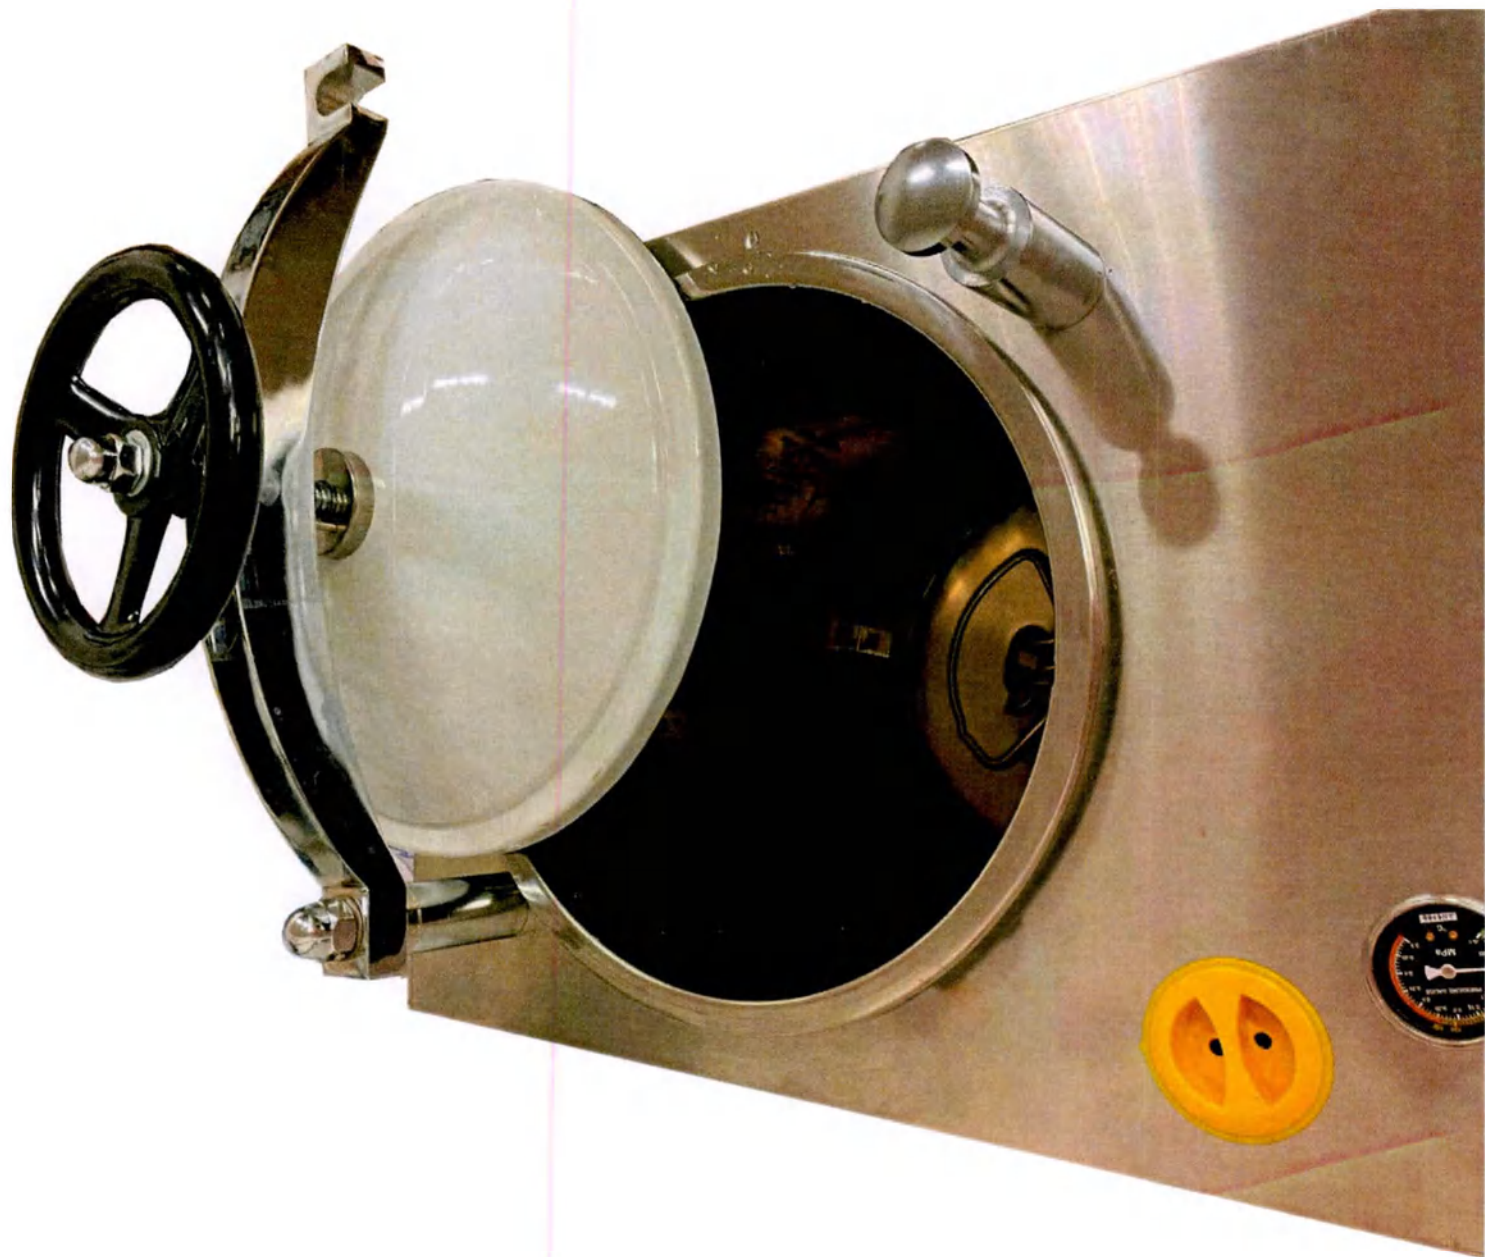



Шредер НБ модуль 2



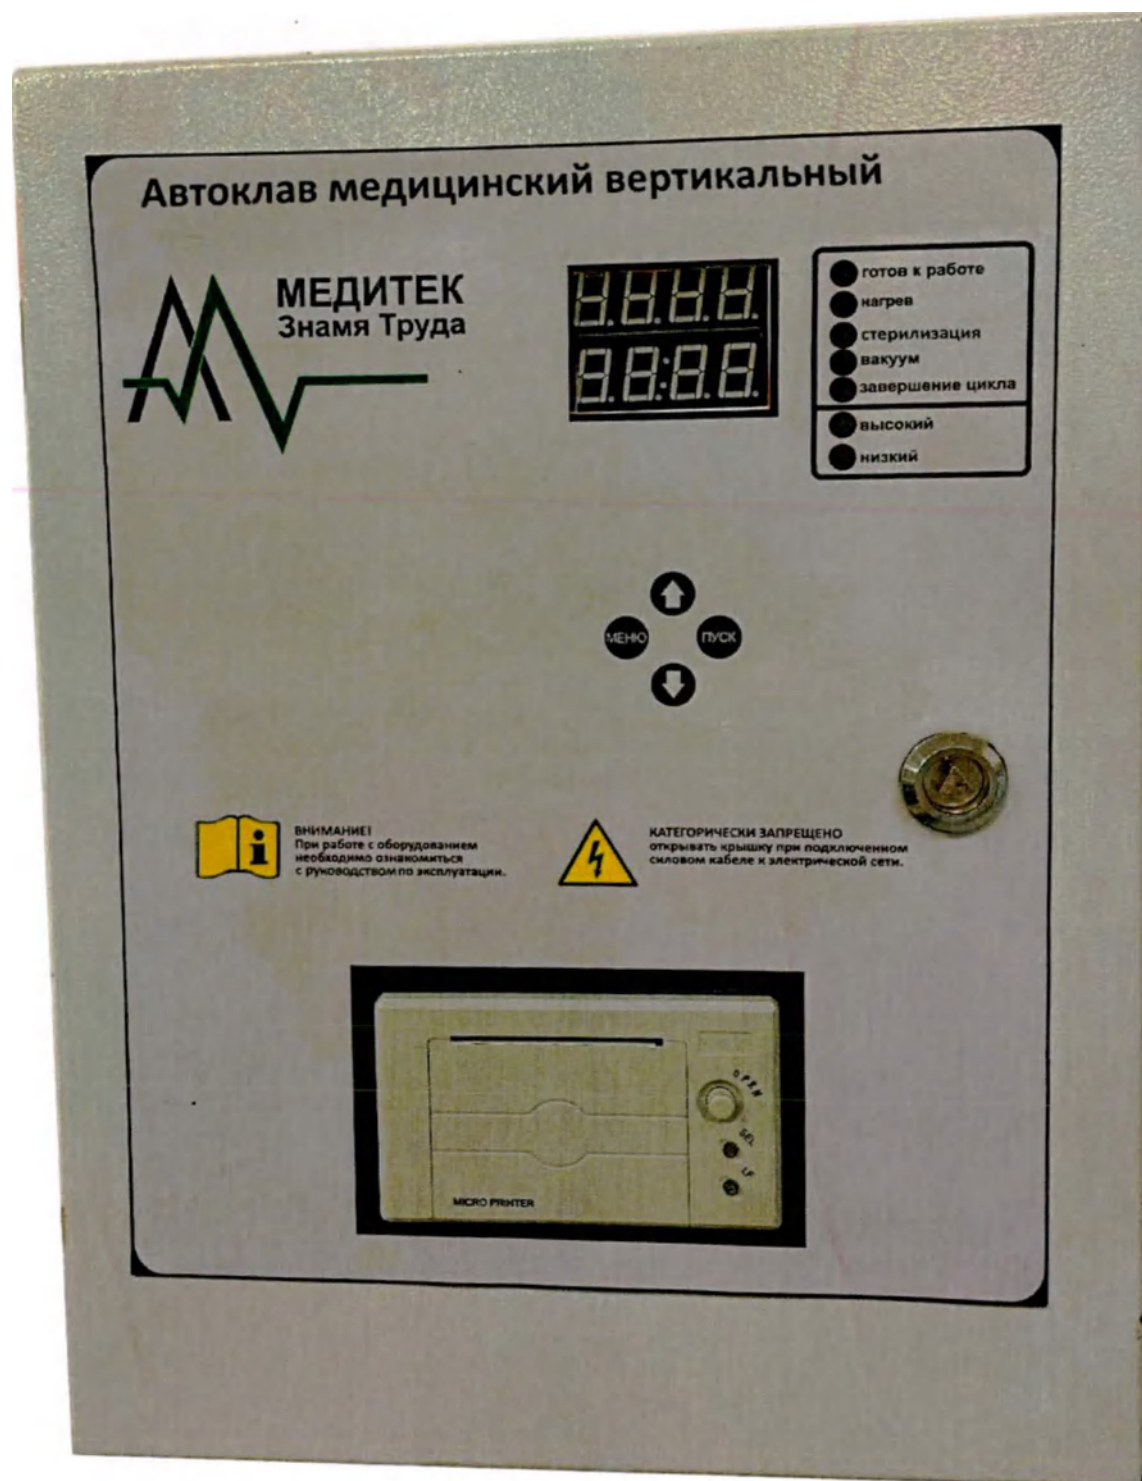

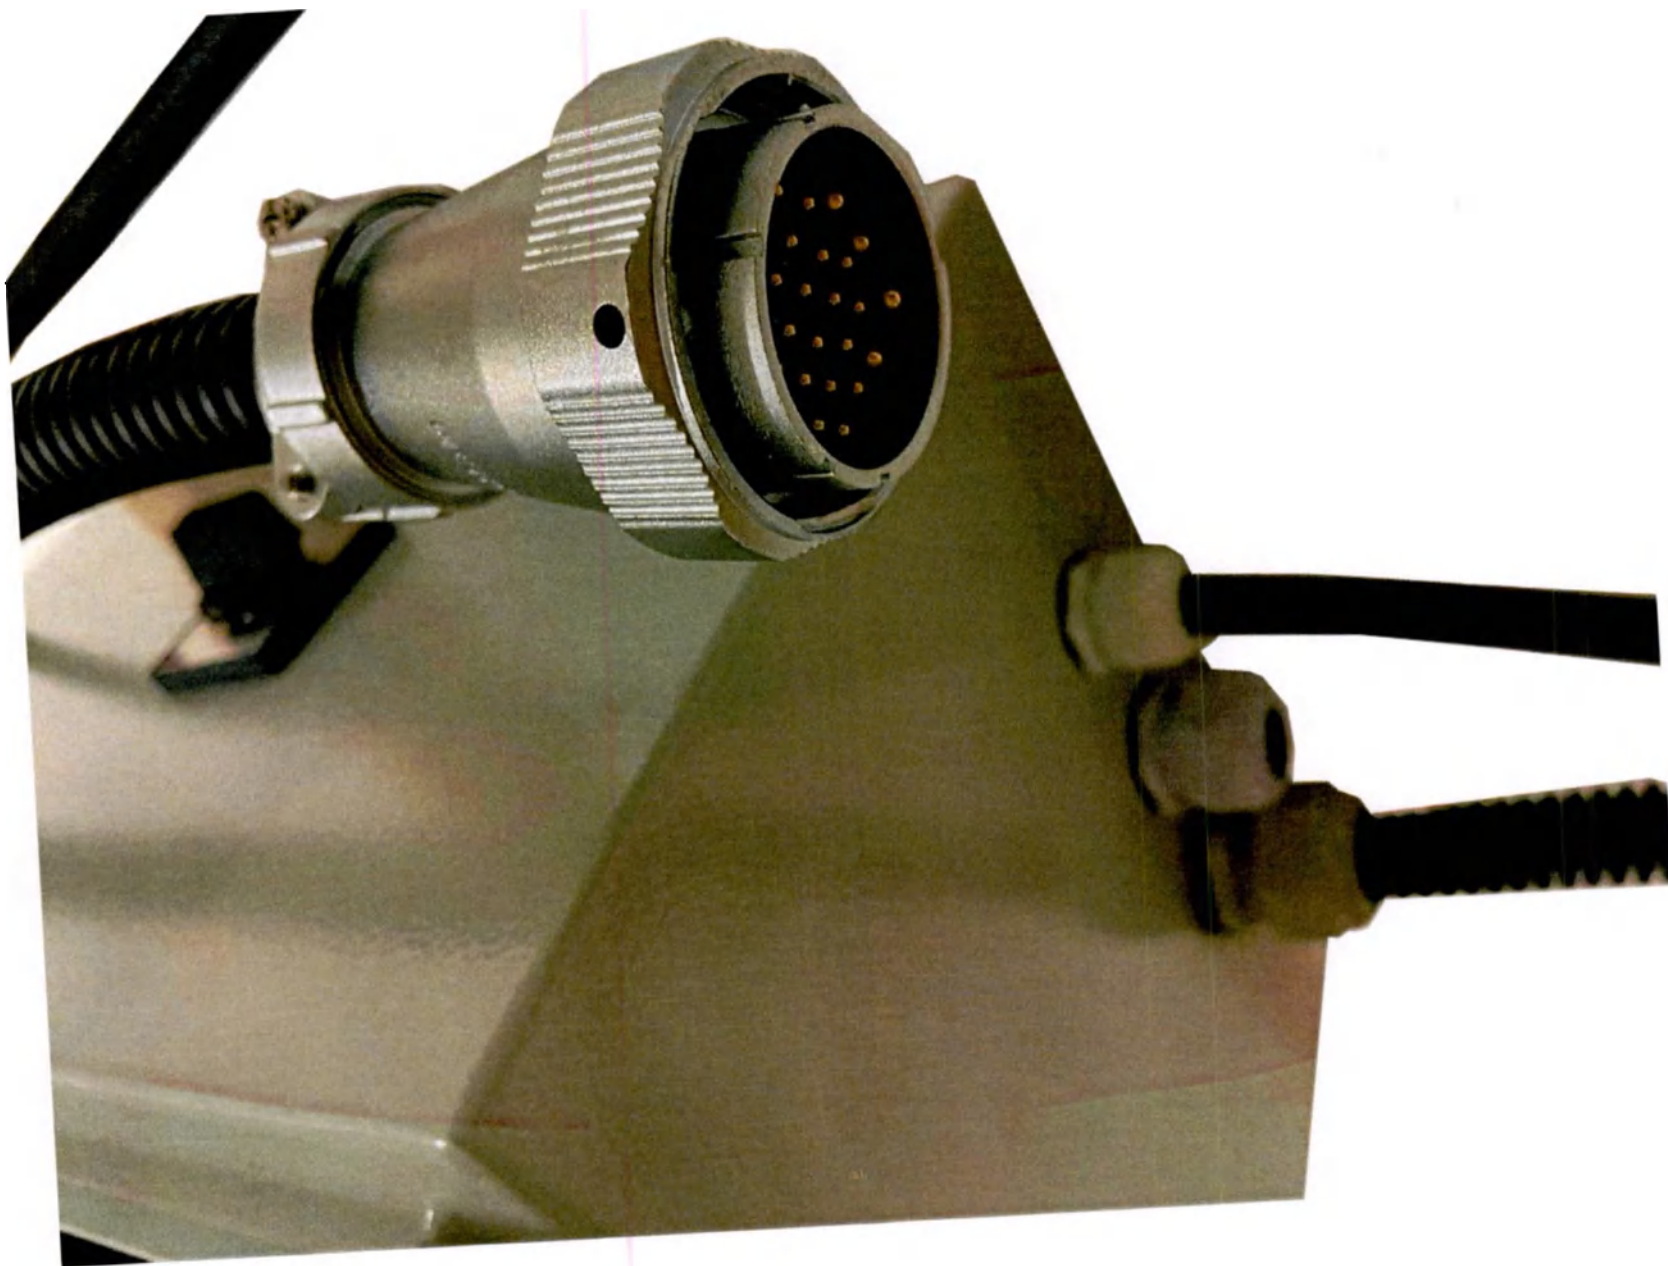

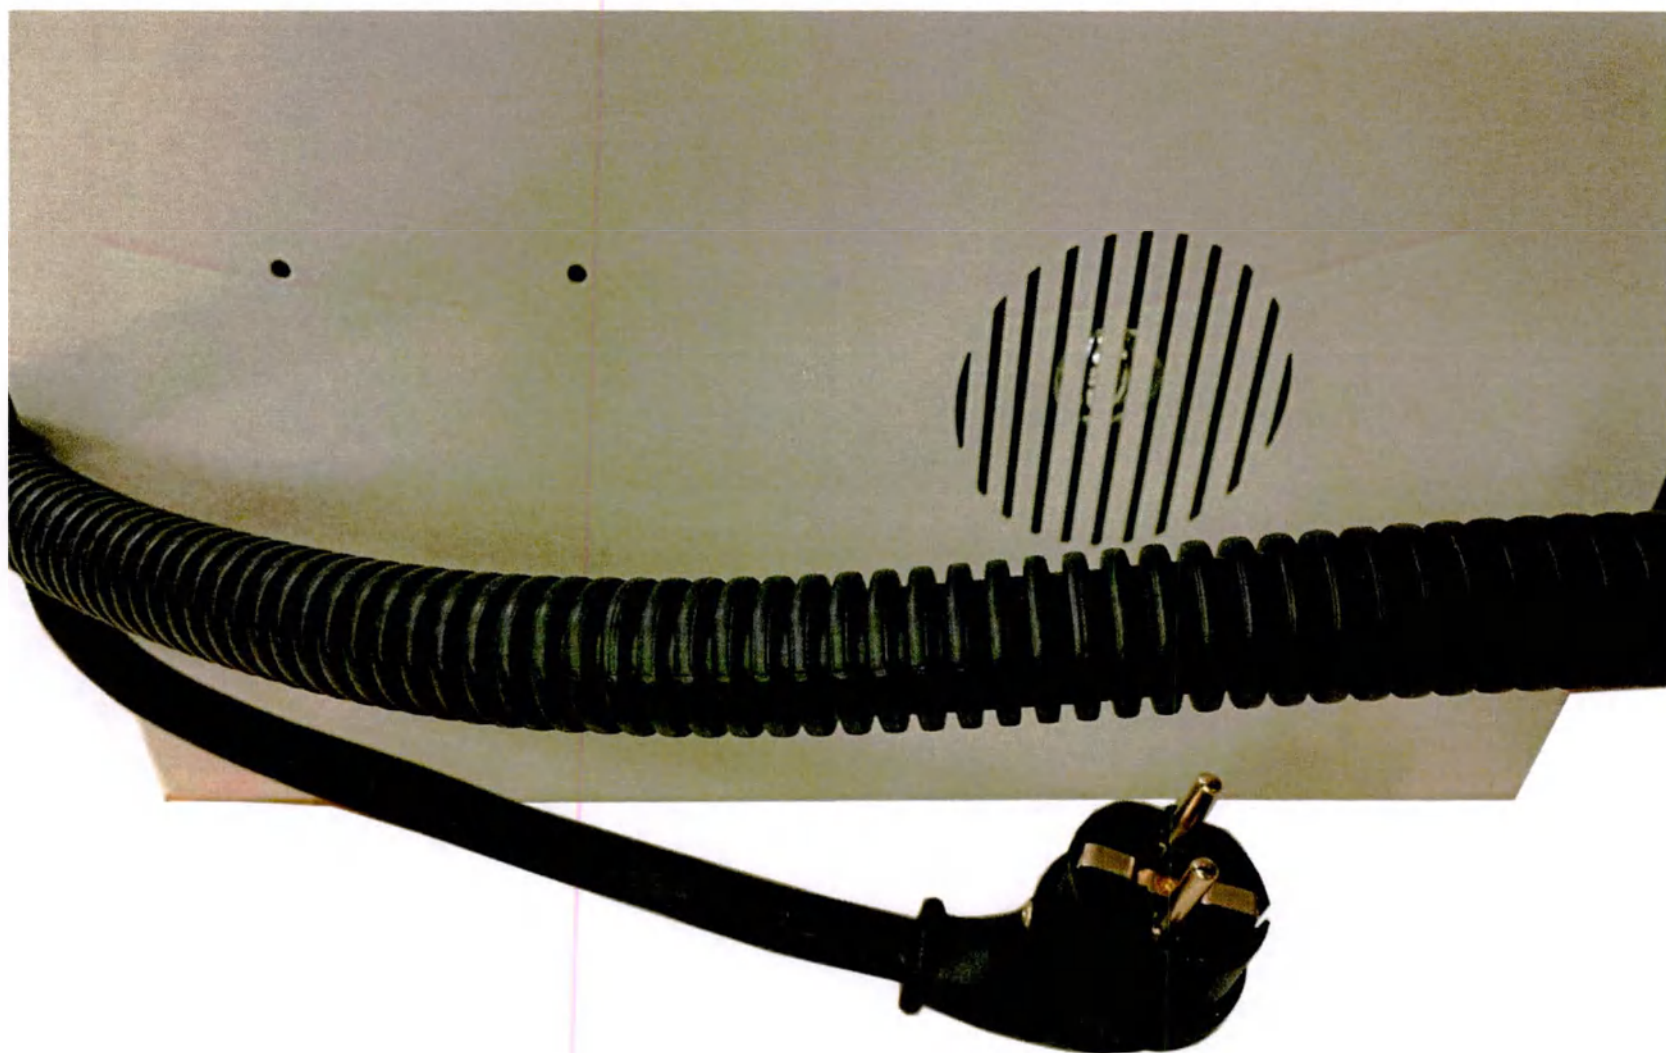

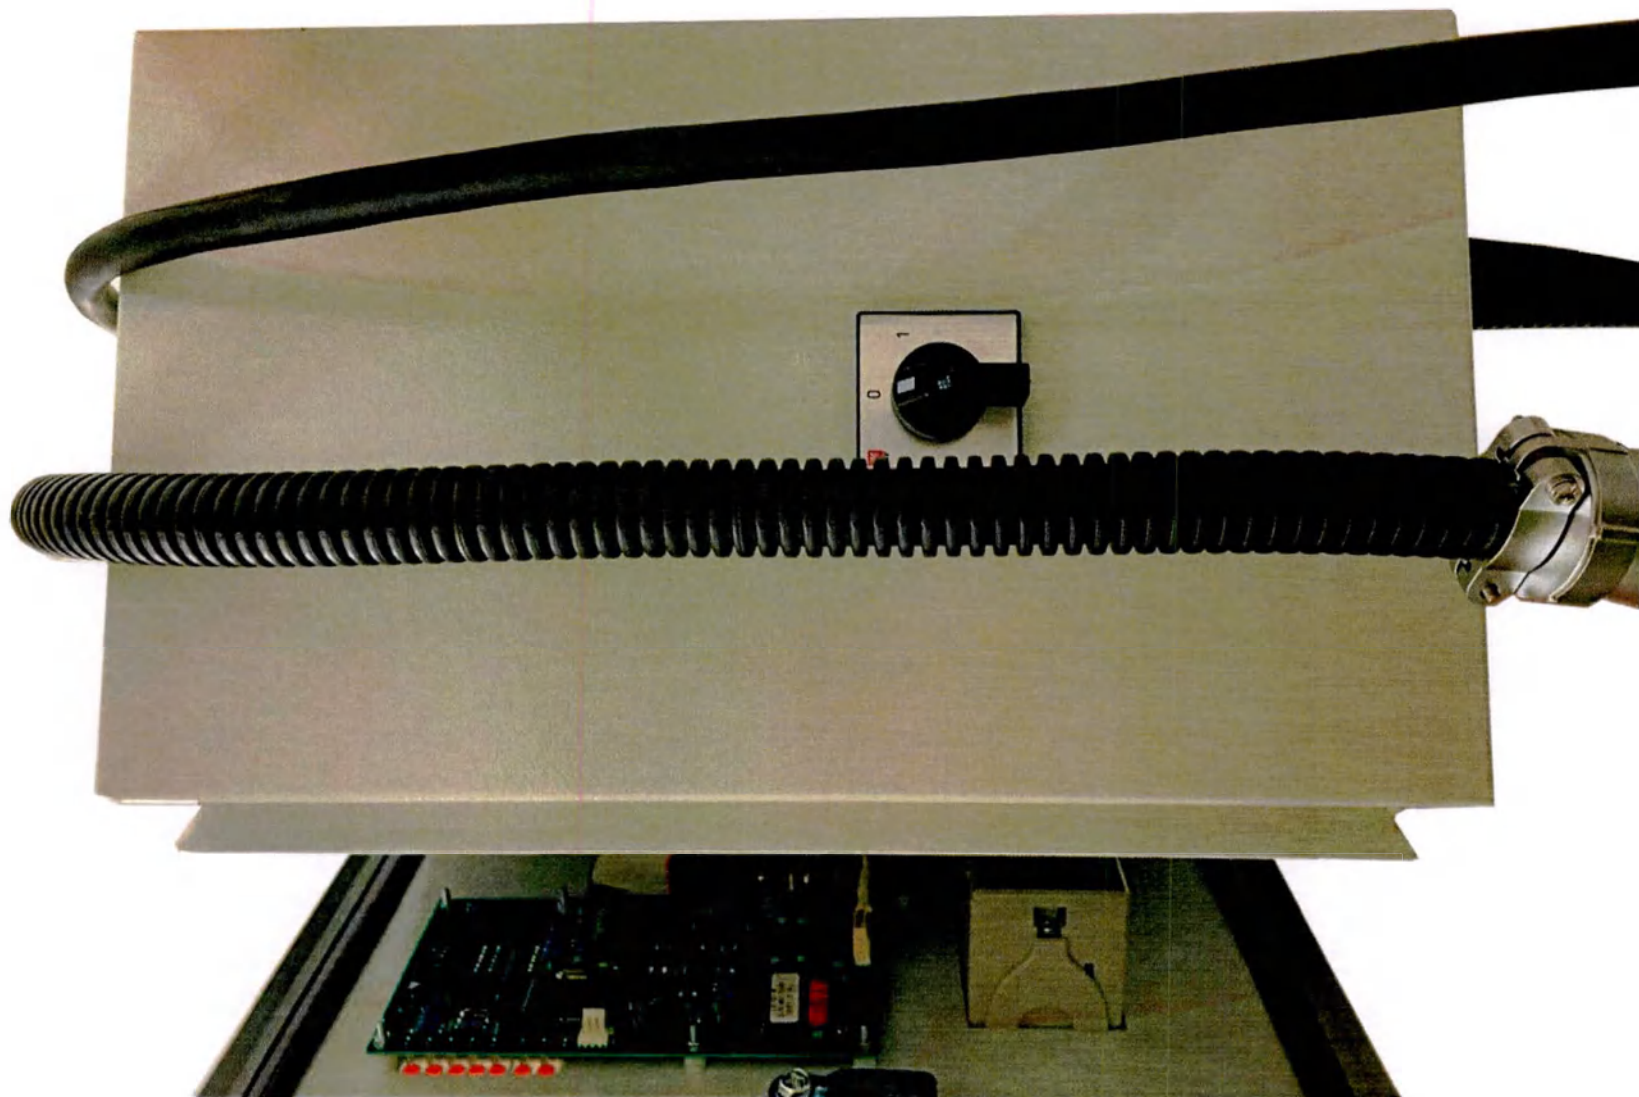



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 НБ»



Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 НБ»




Крючок металлический металлическая



Емкость пластиковая с ручкой и шкалой



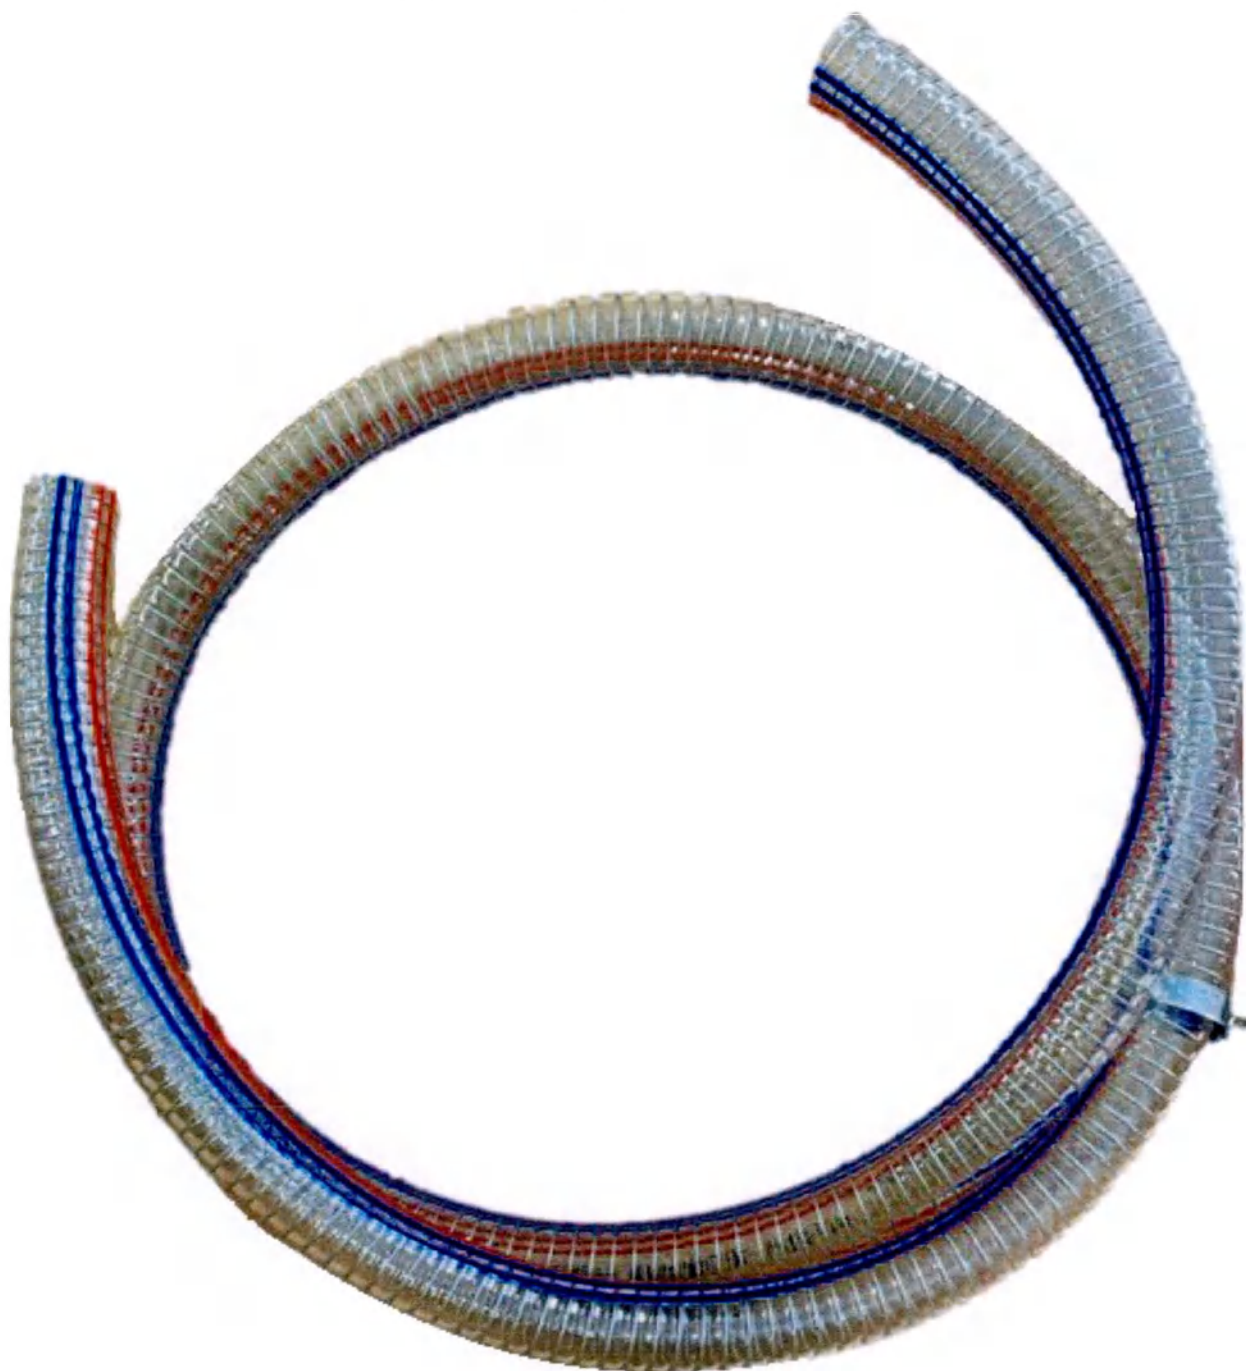

Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00125/1



ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00125/2



ПУ: № _____ / _____ ОТ _____ Г.

Шредер НБ модуль 2



Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru



SN

00125



PY: № / DT



07.2023 г.



00125

19. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш300 НБ»

Автоклав модуль 1-100



Автоклав модуль 1-100




Автоклав модуль 1-100



Камера автоклава модуль 1-100




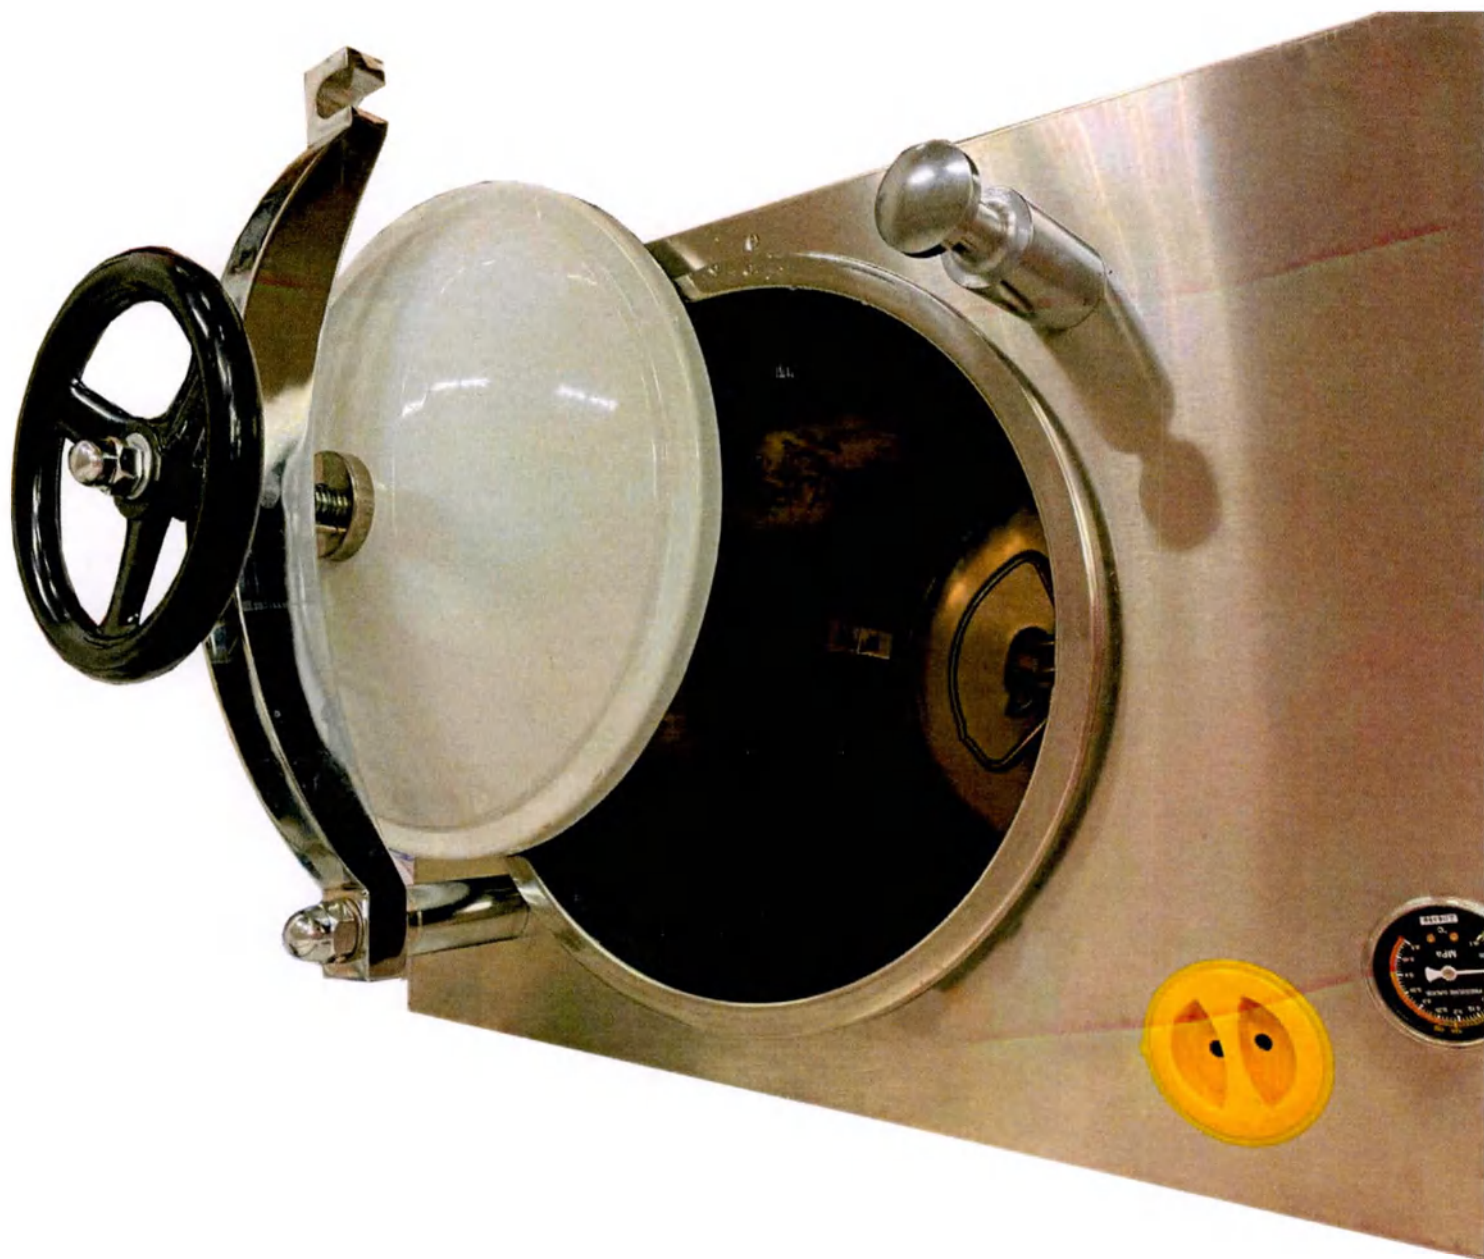



Шредер НБ модуль 2





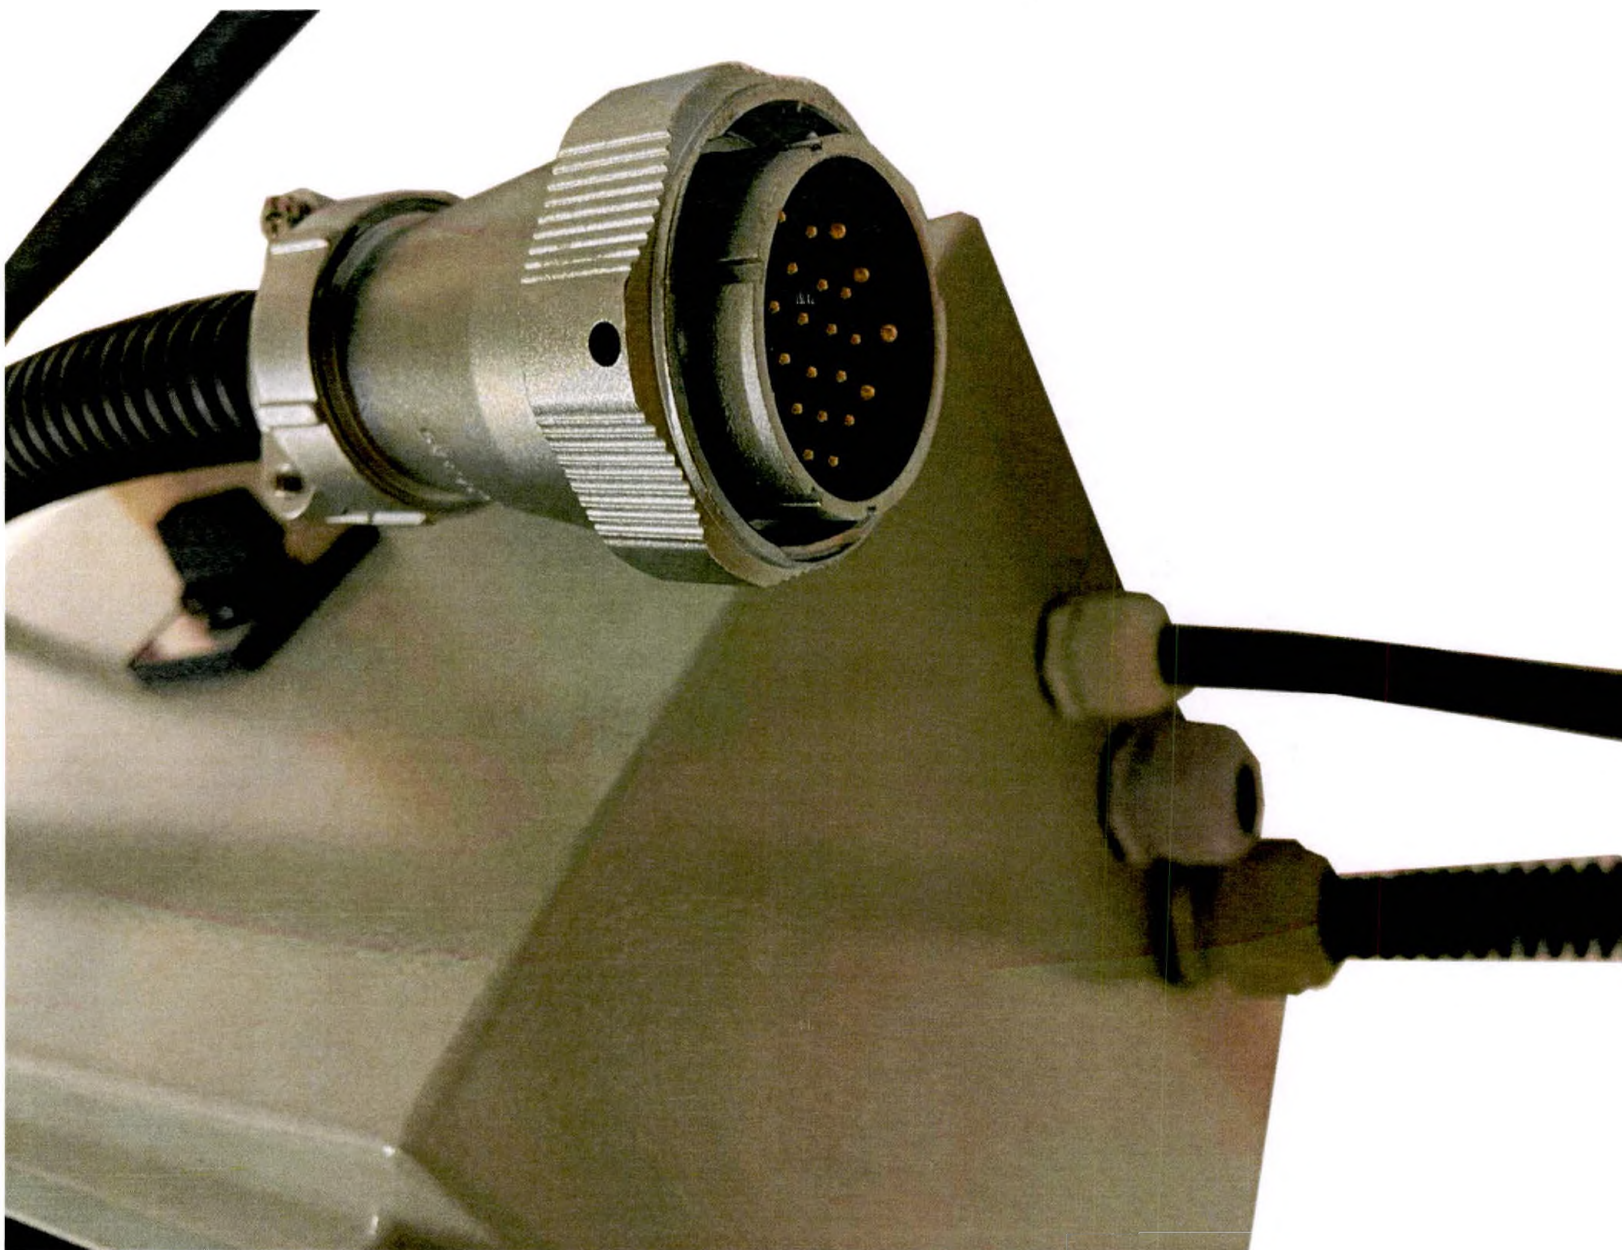

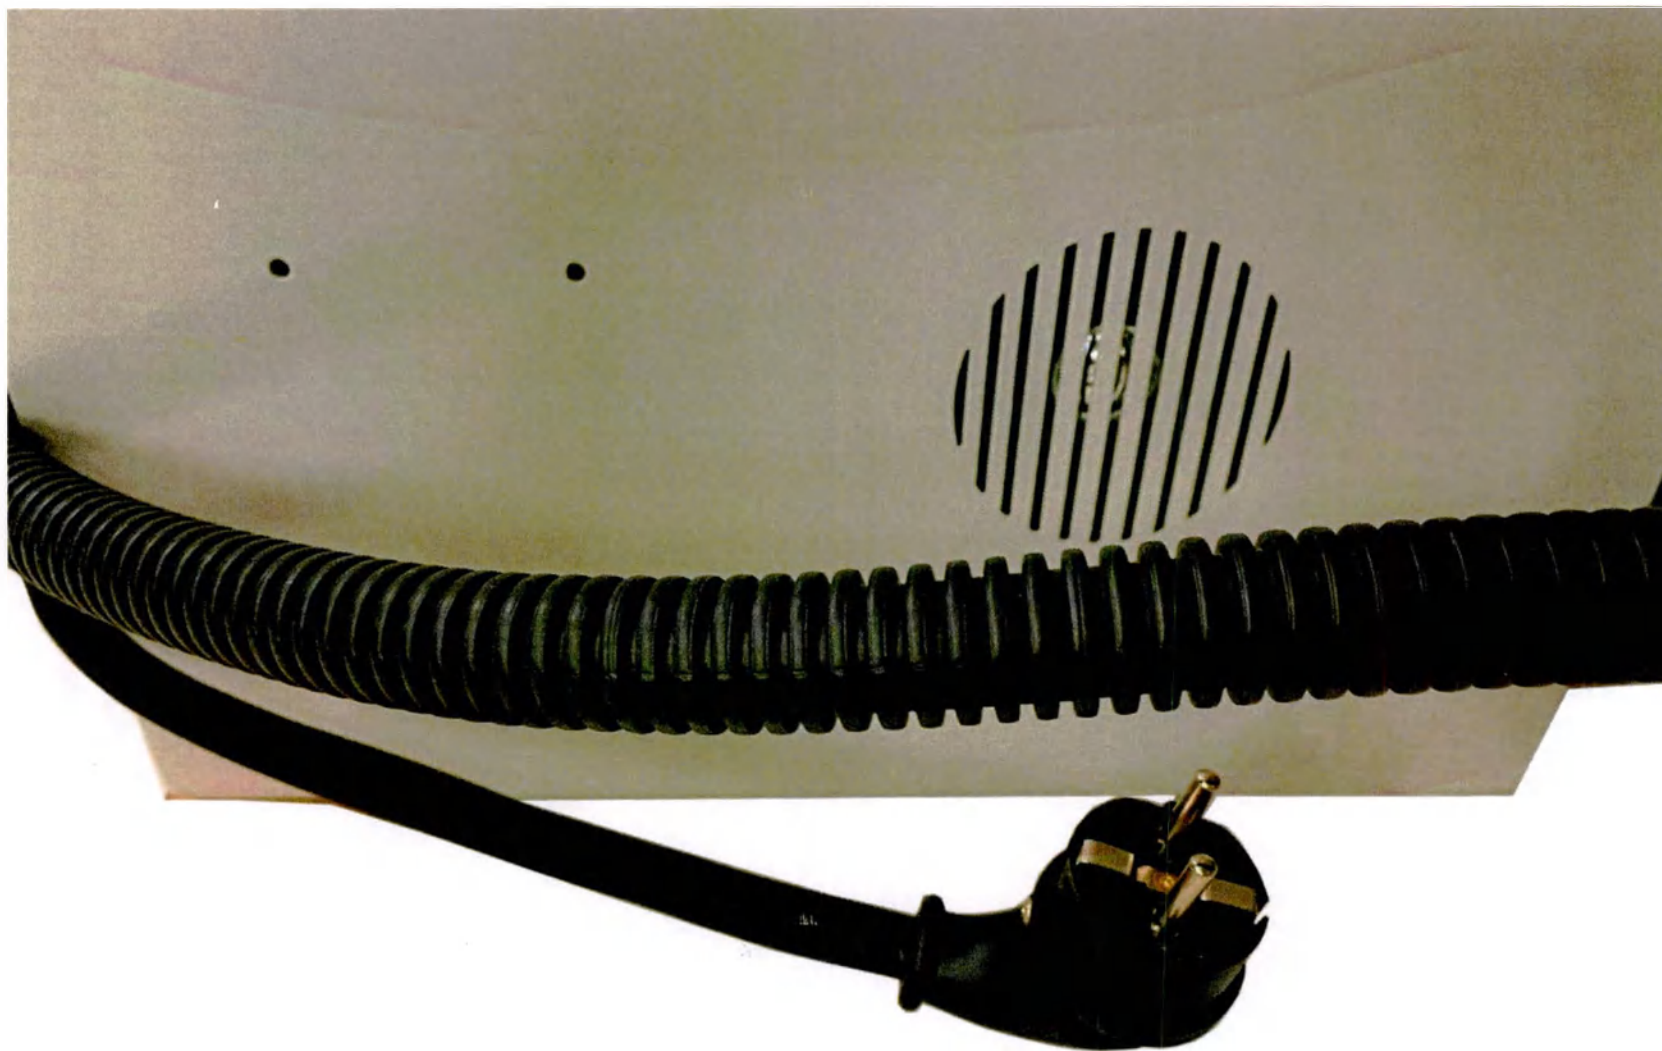

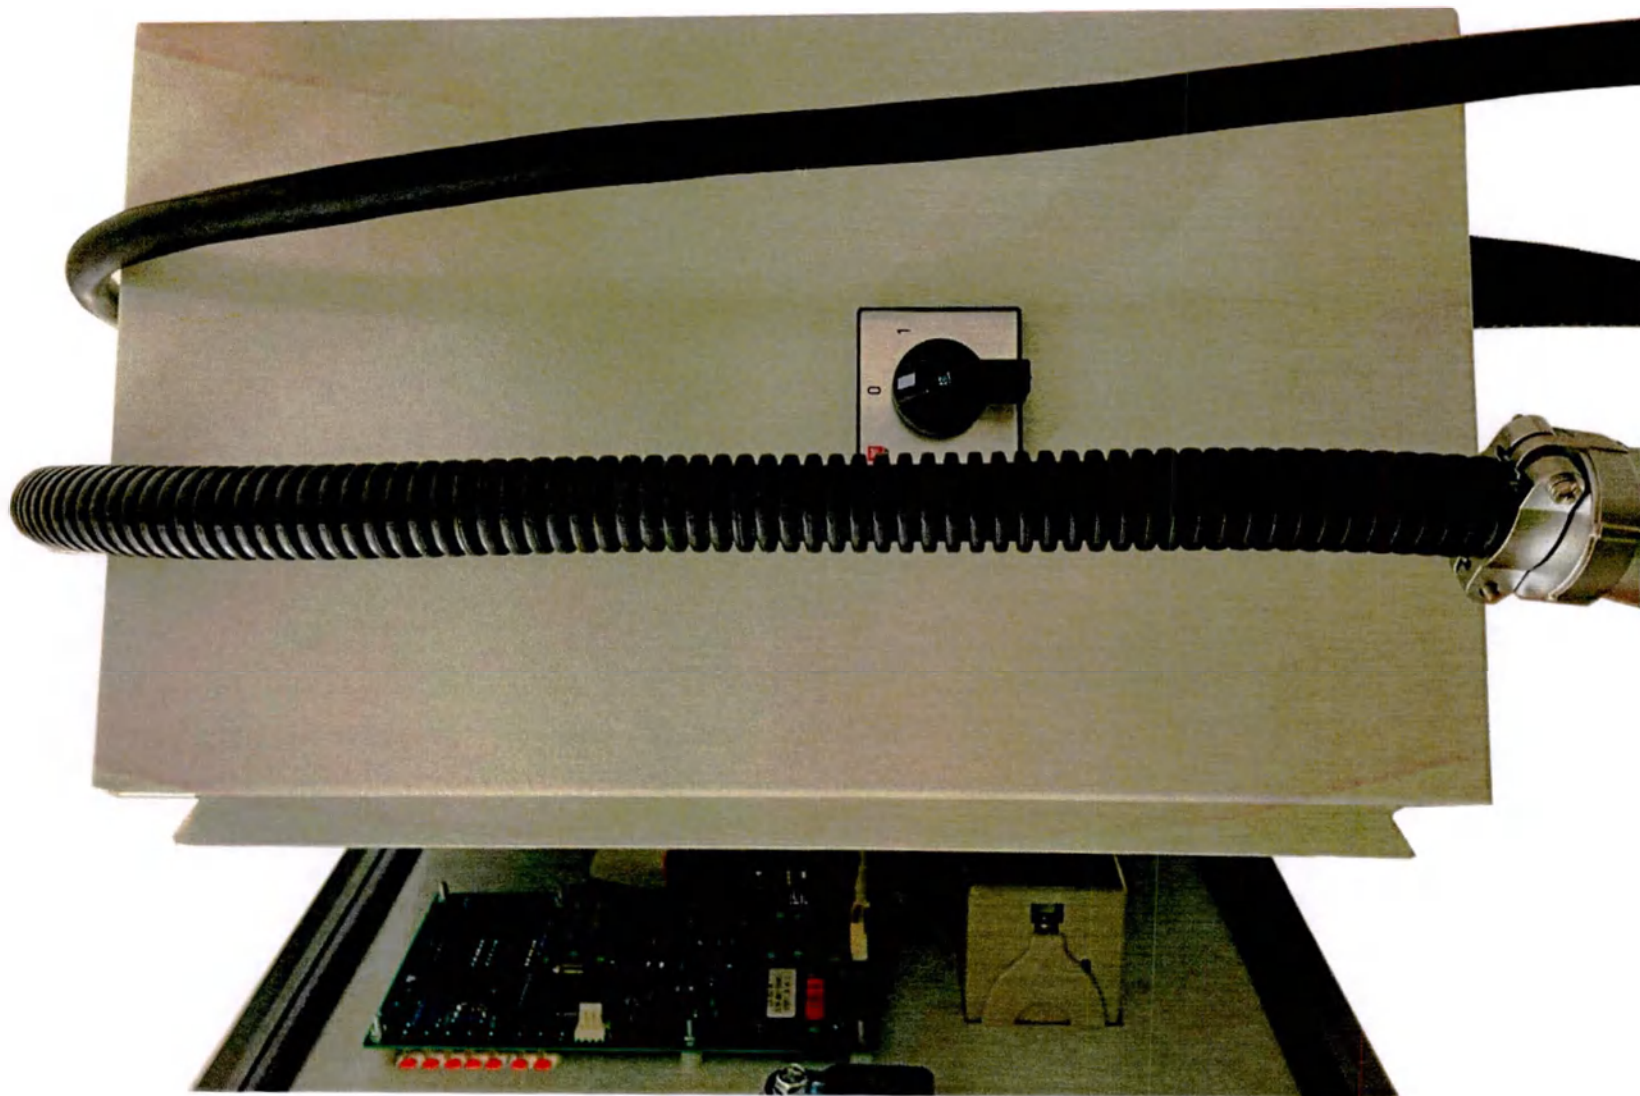



Крышка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш300 НБ»



Подставка перфорированная металлическая «БАЛТНЕР® - Ш300 НБ»





Емкость пластиковая с ручкой и шкалой





Уплотнитель полимерный металлическая



Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00126/1



РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВт

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00126/2



РУ: № _____ / _____ от _____ г.

Маркировка Автоклав модуль 1-100



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-100



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание автоклава: 220 В, ~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 4,5 кВА

Объем стерилизационной камеры: 100 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,021 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,069 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00126/3



РУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер НБ модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер НБ модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczt.ru; Веб-сайт: www.mediteczt.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА



07.2023 г.



00126



РУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш300 НБ»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® -Ш300 НБ»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1
197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.




00126

20. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш200 ПА Н»

Автоклав модуль 1-200ПА (загрузочная сторона)



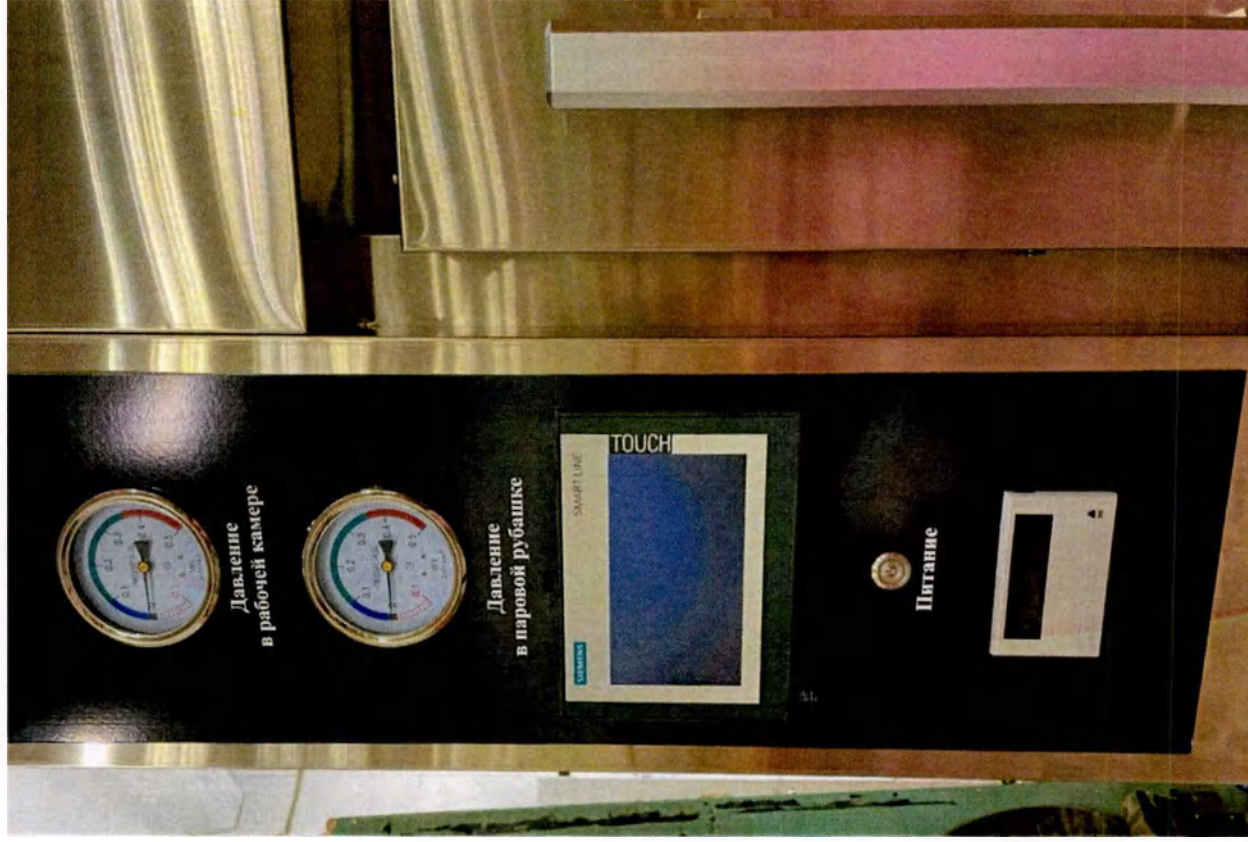


Автоклав модуль 1-200ПА (разгрузочная сторона)





Шредер Н модуль 2

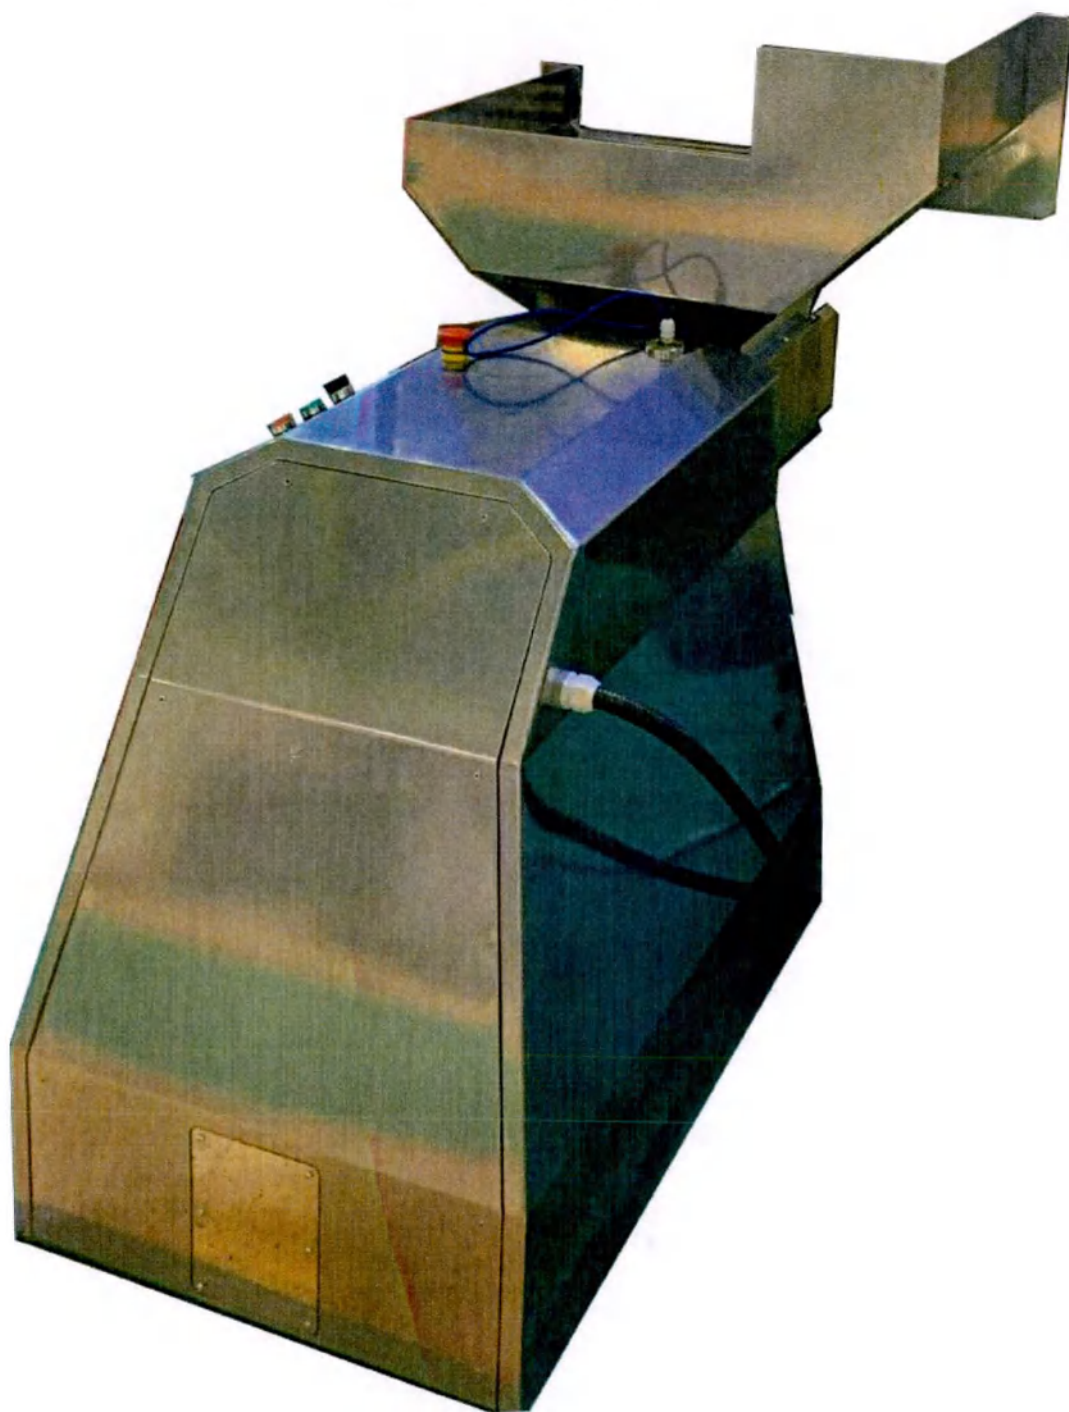

Панель управления системой перегрузки



Решетка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 ПА Н»



Маркировка Автоклава модуль 1-200ПА



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-200ПА



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczl.ru; Веб-сайт: www.mediteczl.ru

Питание автоклава: 380 В, 3~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 23,5 кВА

Объем стерилизационной камеры: 200 л

Максимальная рабочая температура: 134°C

Максимальное рабочее давление: 0,225 МПа

Минимальное рабочее давление: 0,019 МПа

Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00101



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер Н модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер Н модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczl.ru; Веб-сайт: www.mediteczl.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц

Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВА



07.2023 г.



00101



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш200ПА Н»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® - Ш200 ПА Н»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров,
наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@meditecz.ru; Веб-сайт: www.meditecz.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:
XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.



00101

21. Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш». Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш280 ПА Н»

Автоклав модуль 1-280ПА (загрузочная сторона)






Автоклав модуль 1-280ПА (разгрузочная сторона)





Шредер Н модуль 2

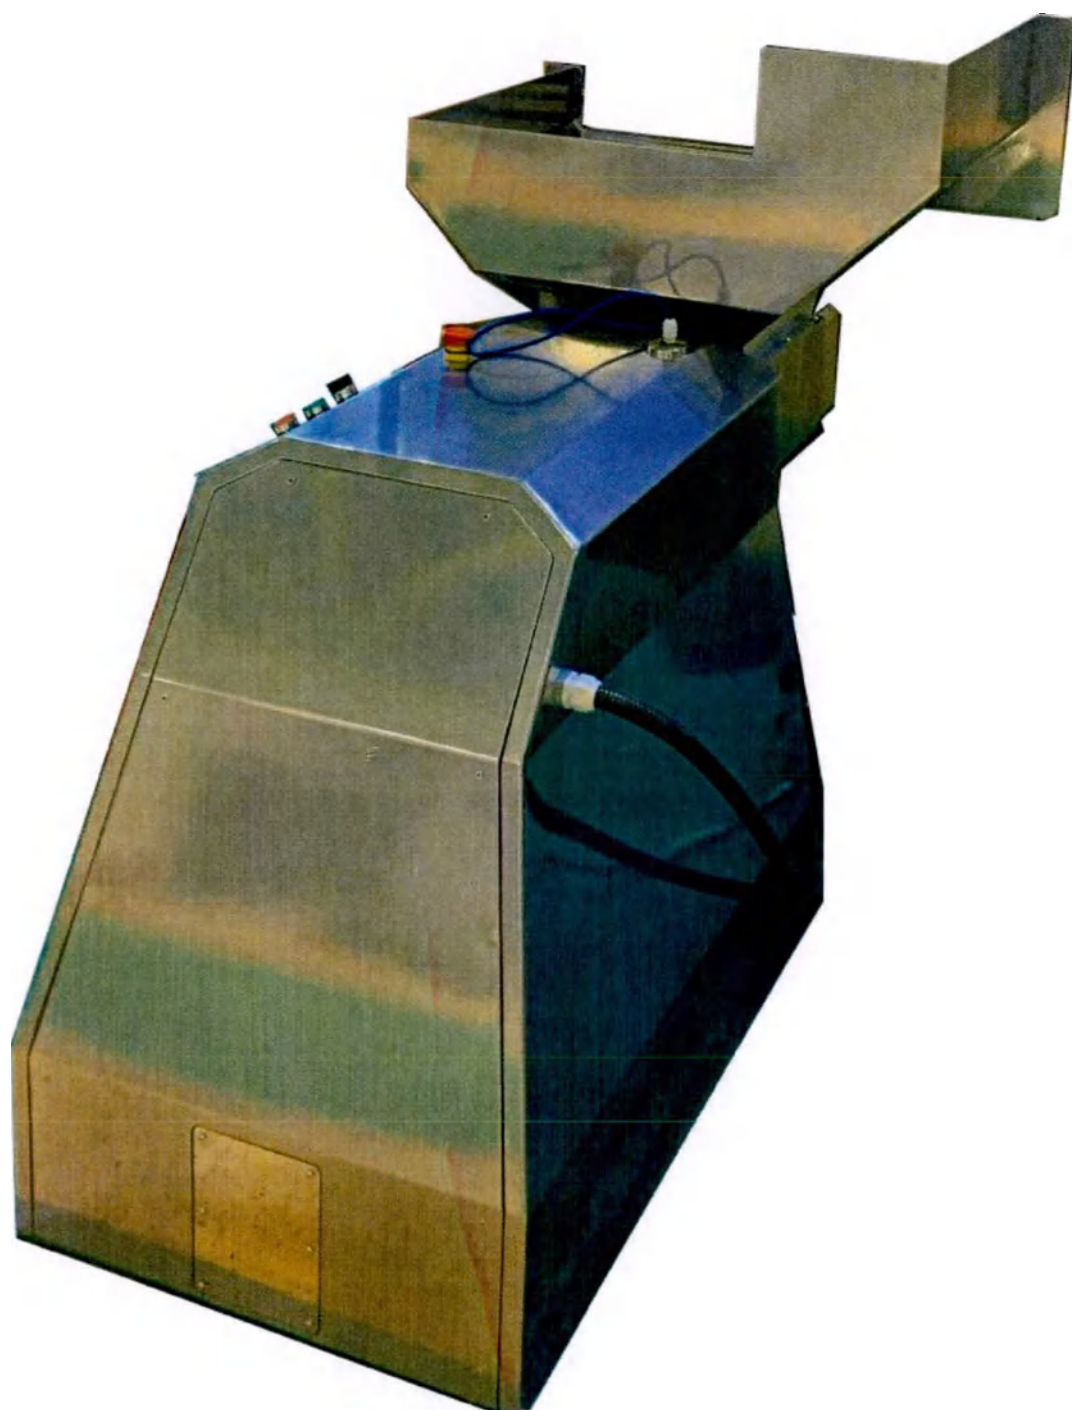

Панель управления системой перегрузки



Решетка металлическая «БАЛТНЕР® - Ш200 ПА Н»



Маркировка Автоклав модуль 1-280ПА Н



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Автоклав модуль 1-280ПА



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczf.ru; Веб-сайт: www.mediteczf.ru

Питание автоклава: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 26,0 кВт
Объем стерилизационной камеры: 280 л
Максимальная рабочая температура: 134°C
Максимальное рабочее давление: 0,225 МПа
Минимальное рабочее давление: 0,019 МПа
Пробное (испытательное) давление в камере: 0,29 МПа



07.2023 г.



00100



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Маркировка Шредер Н модуль 2



УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

Шредер Н модуль 2



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1
Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczf.ru; Веб-сайт: www.mediteczf.ru

Питание шредера: 380 В, 3~ 50 Гц
Потребляемая мощность, не более: 9,0 кВт



07.2023 г.



00100



ПУ: № ____ / ____ от ____ г.

Транспортная маркировка Установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш280ПА Н»

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

«БАЛТНЕР® - Ш»

по ТУ 32.50.50-036-61014306-2023

«БАЛТНЕР® - Ш280 ПА Н»

Грузоотправитель:



АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Аптекарский остров, наб. Реки Карповки, д. 5, к. 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Тел.: +7 (812) 622-10-15; E-mail: info@mediteczrt.ru; Веб-сайт: www.mediteczrt.ru

Грузополучатель: XXXXXXXXXX

Пункт отправления: АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», 195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литера «С», помещение № 2/1

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Морская улица, дом 27, литера А

Пункт назначения: XXXXXXXXXX

Брутто: XXX кг

Нетто: XXX кг



Габаритные размеры грузового места:

XXX x XXX x XXX см



07.2023 г.



00100

Установка для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «БАЛТНЕР® - Ш».
Исполнение «БАЛТНЕР® - Ш200 ПА Н», «БАЛТНЕР® - Ш280 ПА Н». Общий вид



Прочито, пронумеровано и скреплено печатью:

Диссер. медицинск. наук 355 листов

Генеральный директор
АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Крутицкий Д.Е.

М.П.

«19»

ноября

2024 года

