



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Дельруском»

А.Е. Алёхин

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 188 от 07.09.2023 «02» августа 2024 г.


М.П.

М В КУЛЯС

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид сверху.

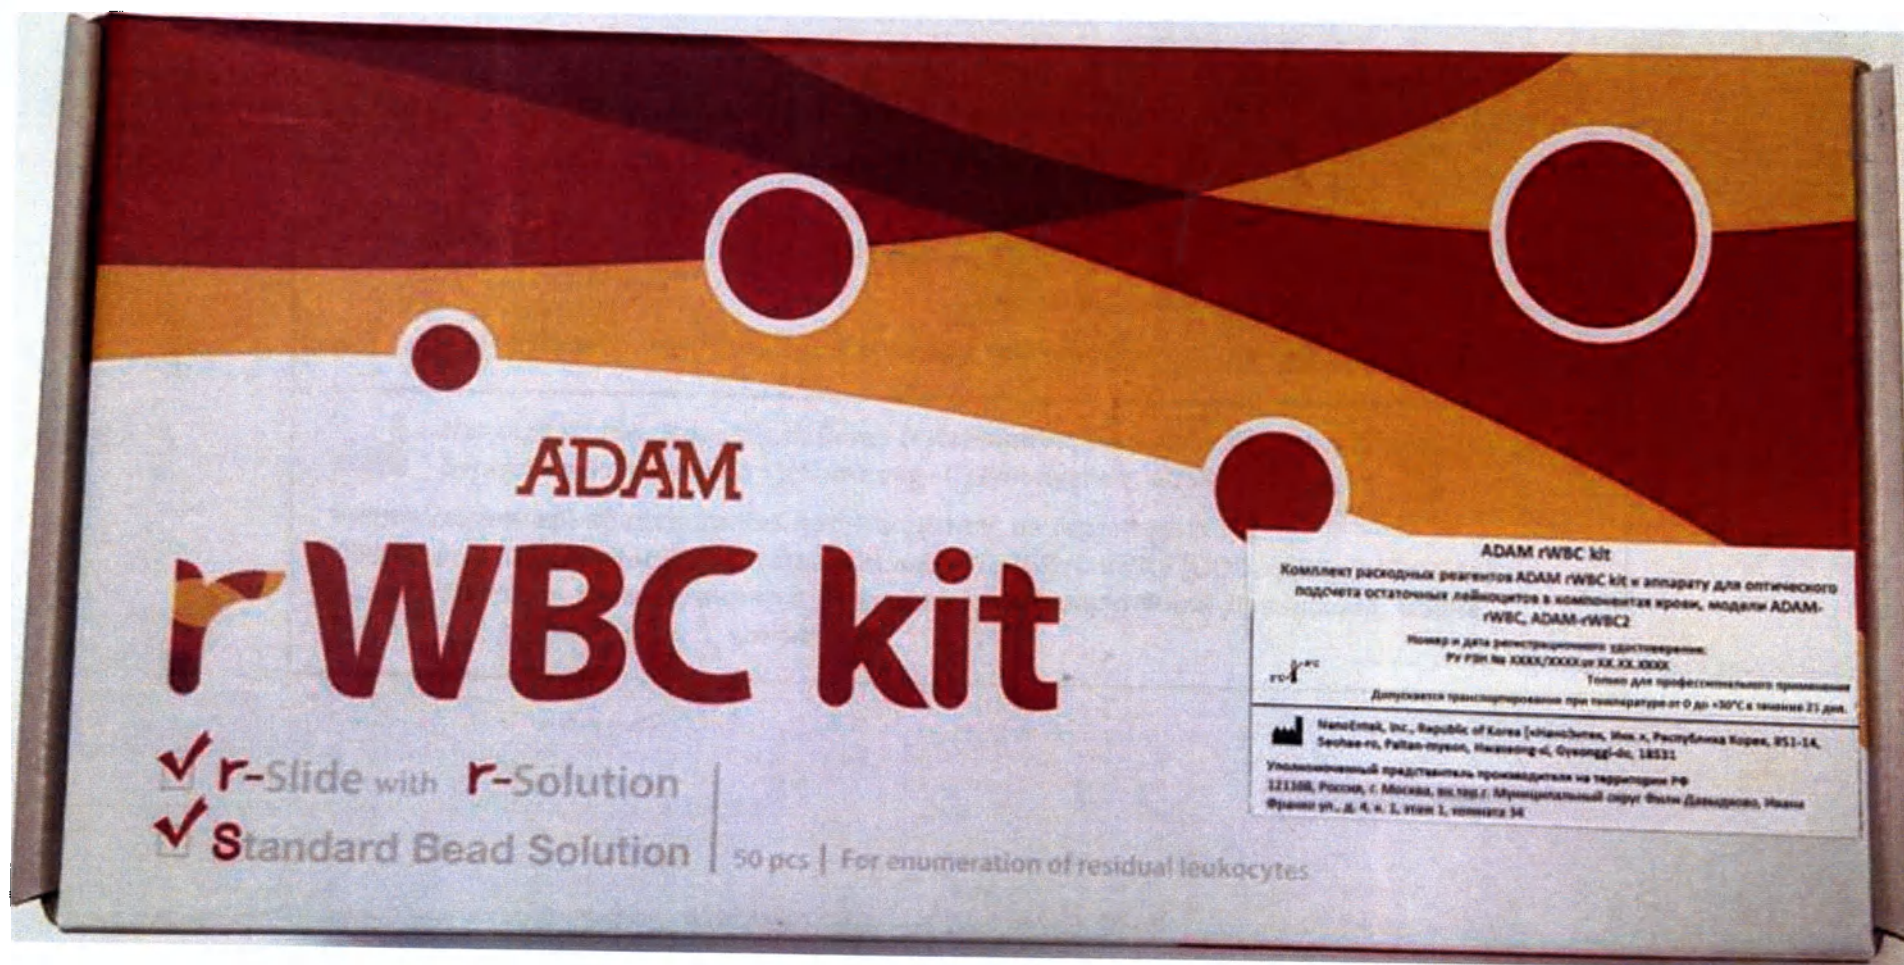

Макет русскоязычной маркировки потребительской упаковки

ADAM rWBC kit

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2

Номер и дата регистрационного удостоверения:

РУ № РЗН 2015/2883 от _____.____.



Только для профессионального применения


Допускается транспортирование при температуре от 0 до +30°C в течение 21 дня.



NanoEntek, Inc., Republic of Korea («НаноЭнтек, Инк.», Республика Корея, 851-14, Seohaee-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18531

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬРУСКОМ» (ООО «ДЕЛЬРУСКОМ»),
121108, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Фили-Давыдовское, Изана
Франко ул., д. 4, к. 1, этаж 1, комната 34


Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид спереди.

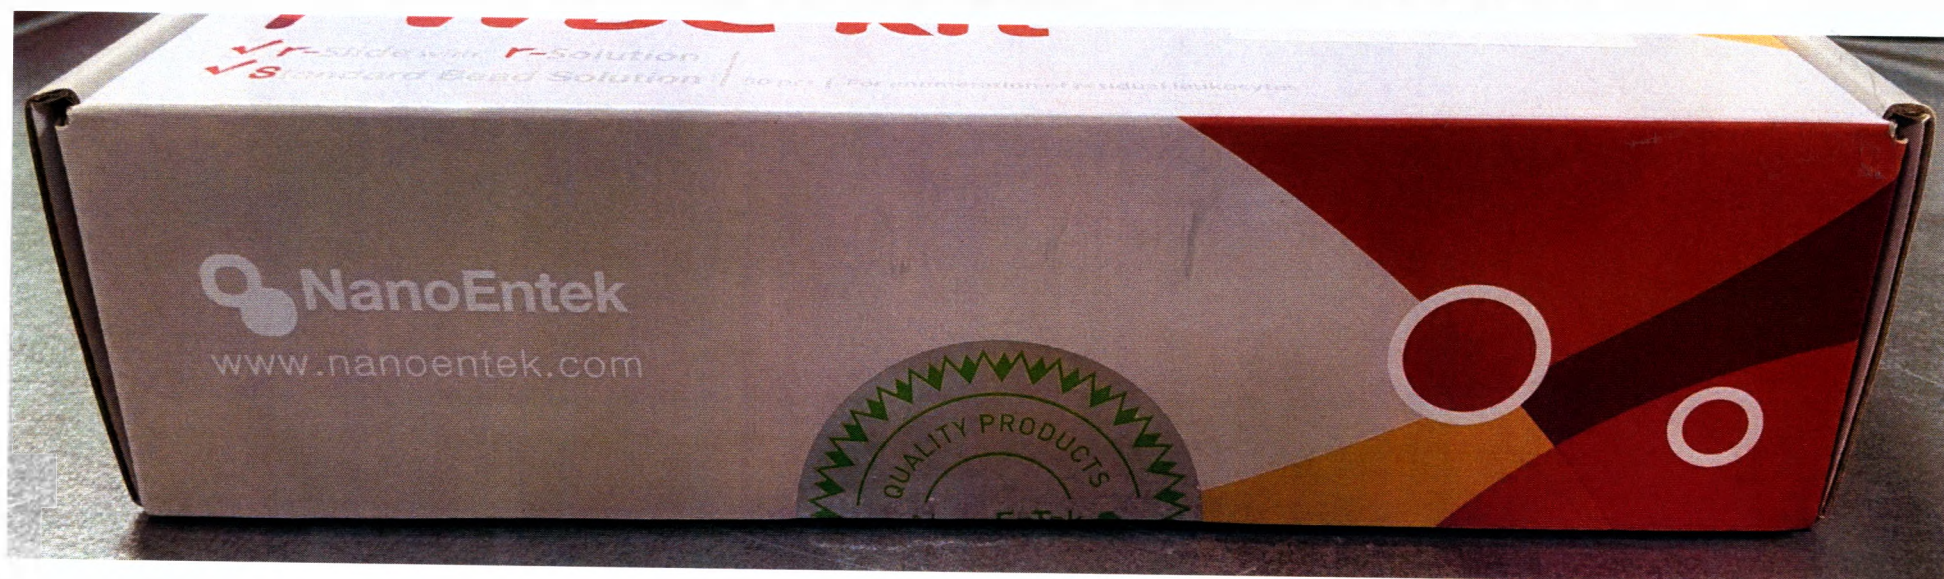


т расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитарных компонентов крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид сбоку.



Упаковка для комплекта расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид сзади.

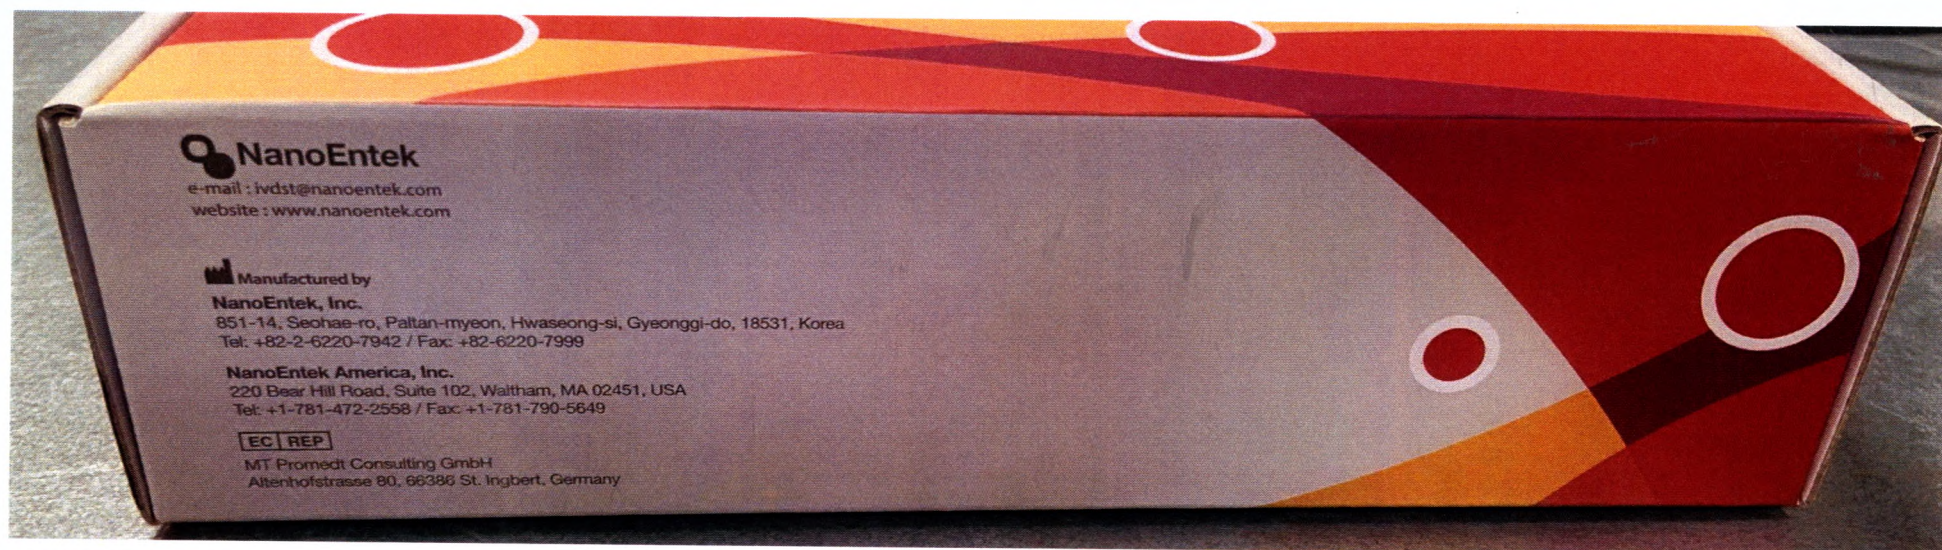


Упаковка для комплекта расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид сбоку.

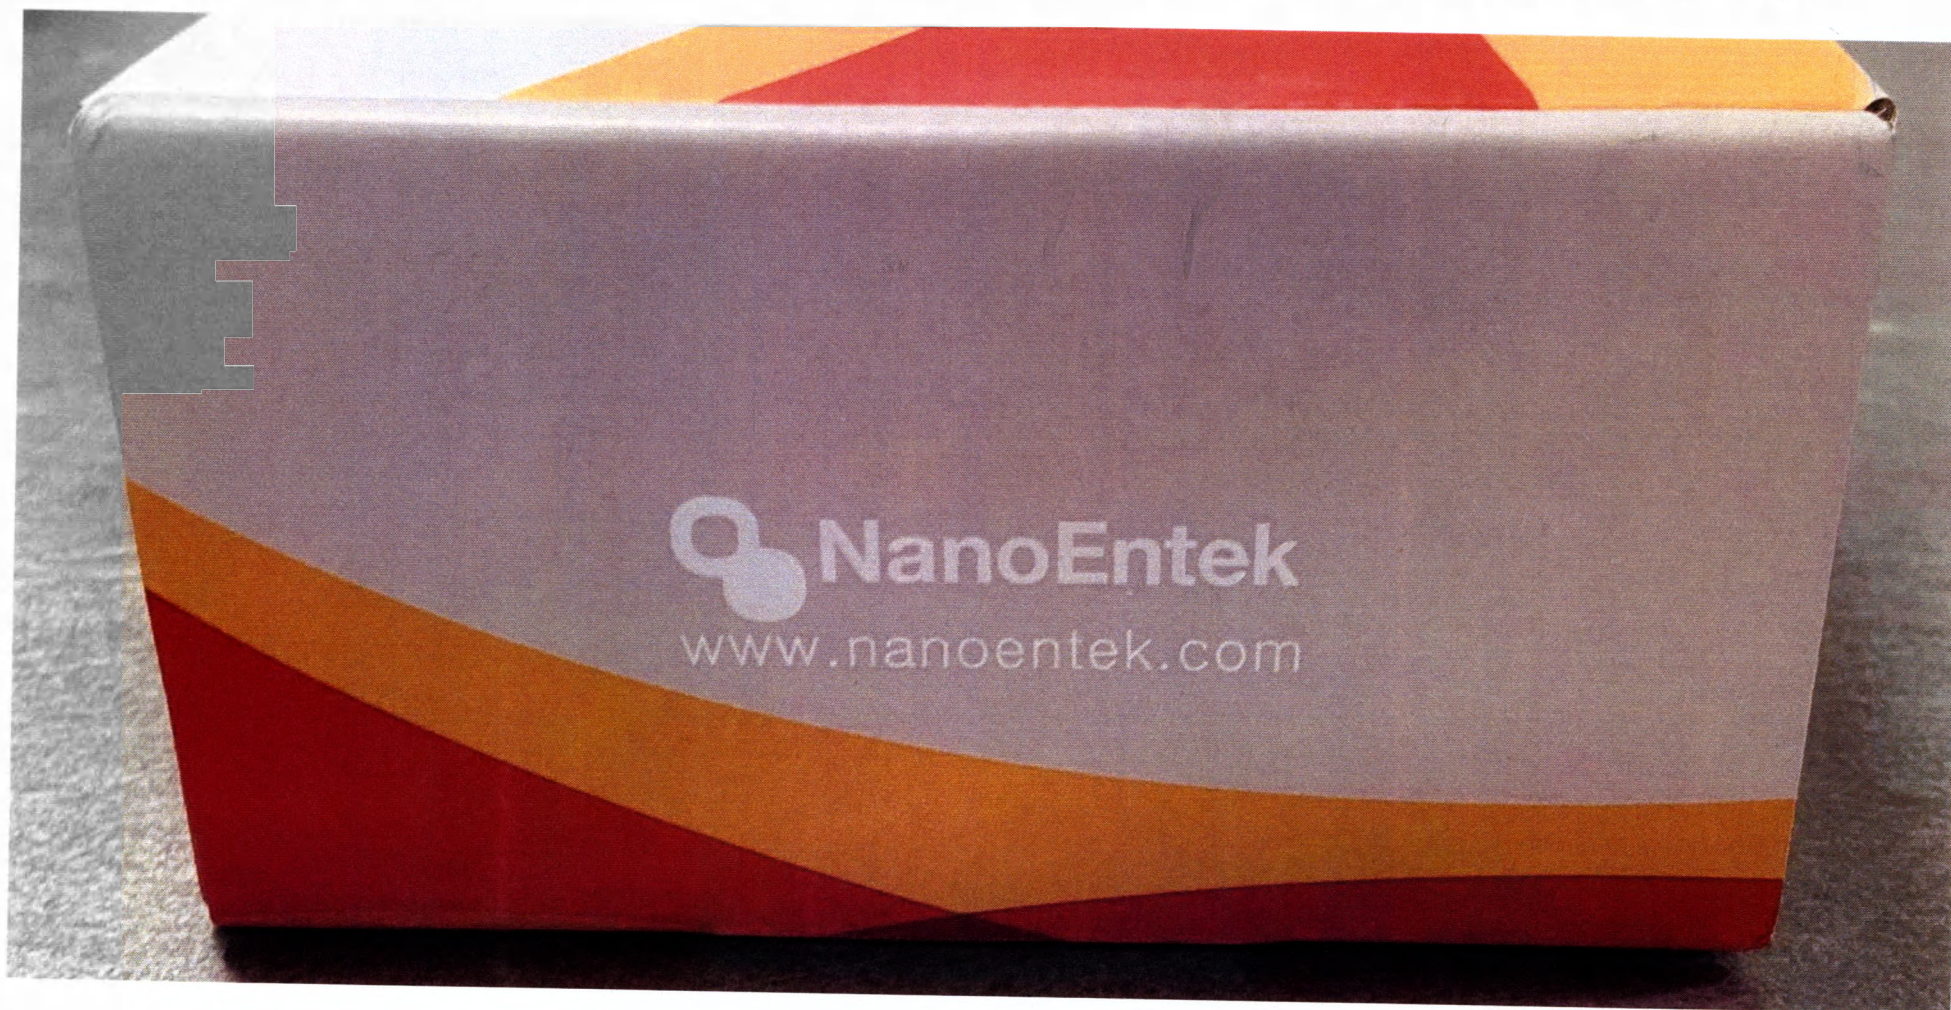


Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Вид внутри упаковки.




Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Вид сверху.

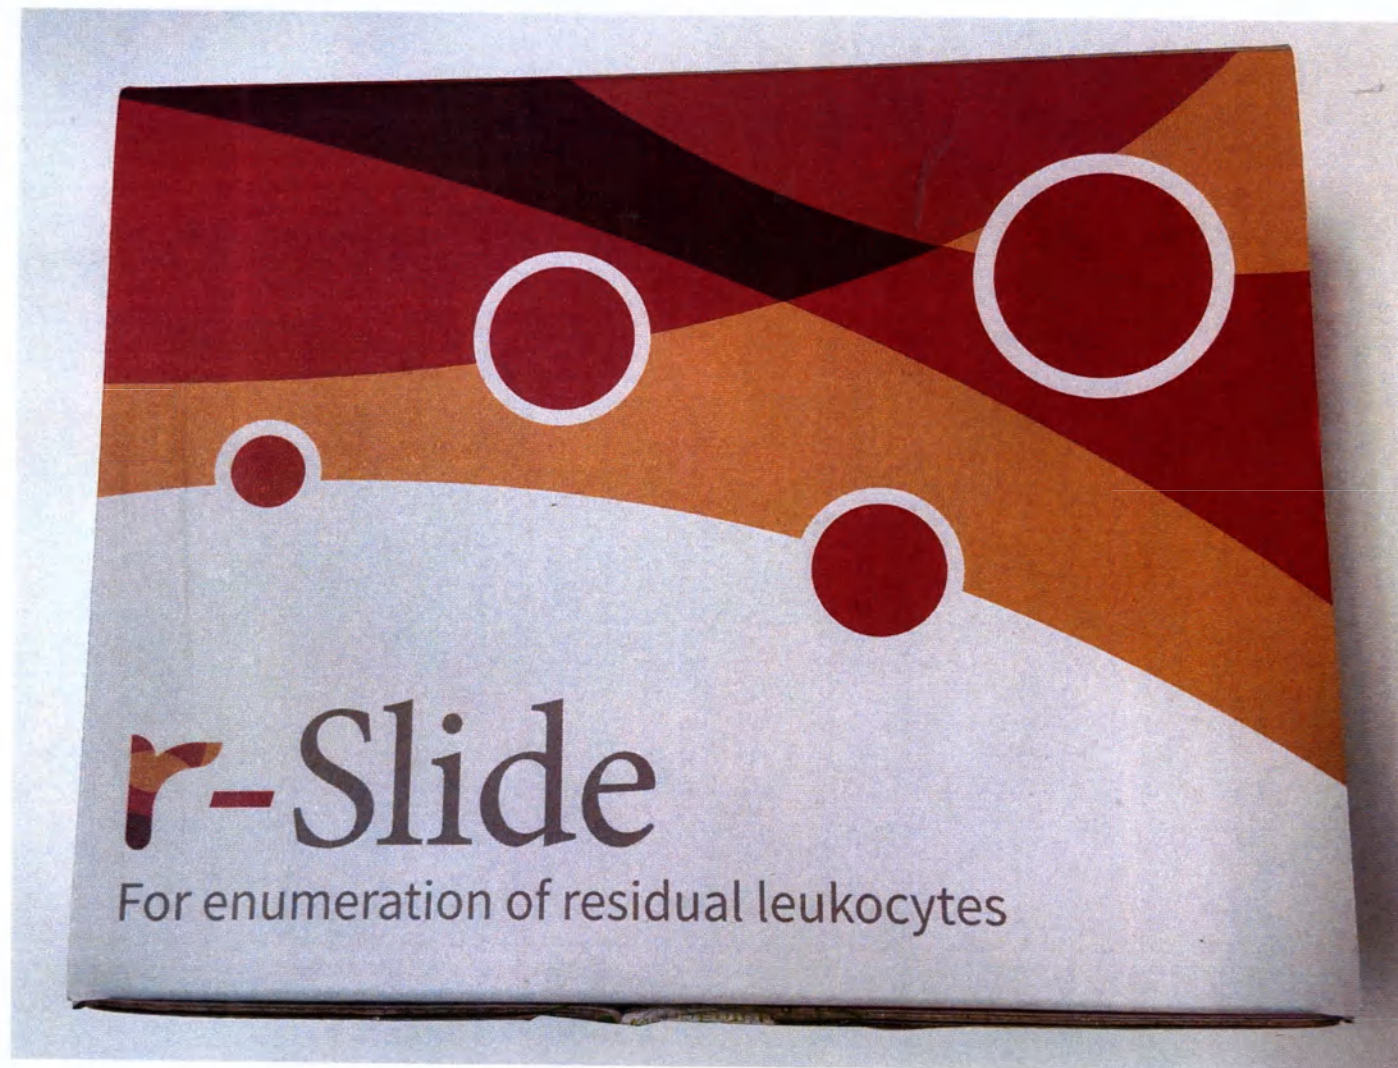


Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Вид спереди.

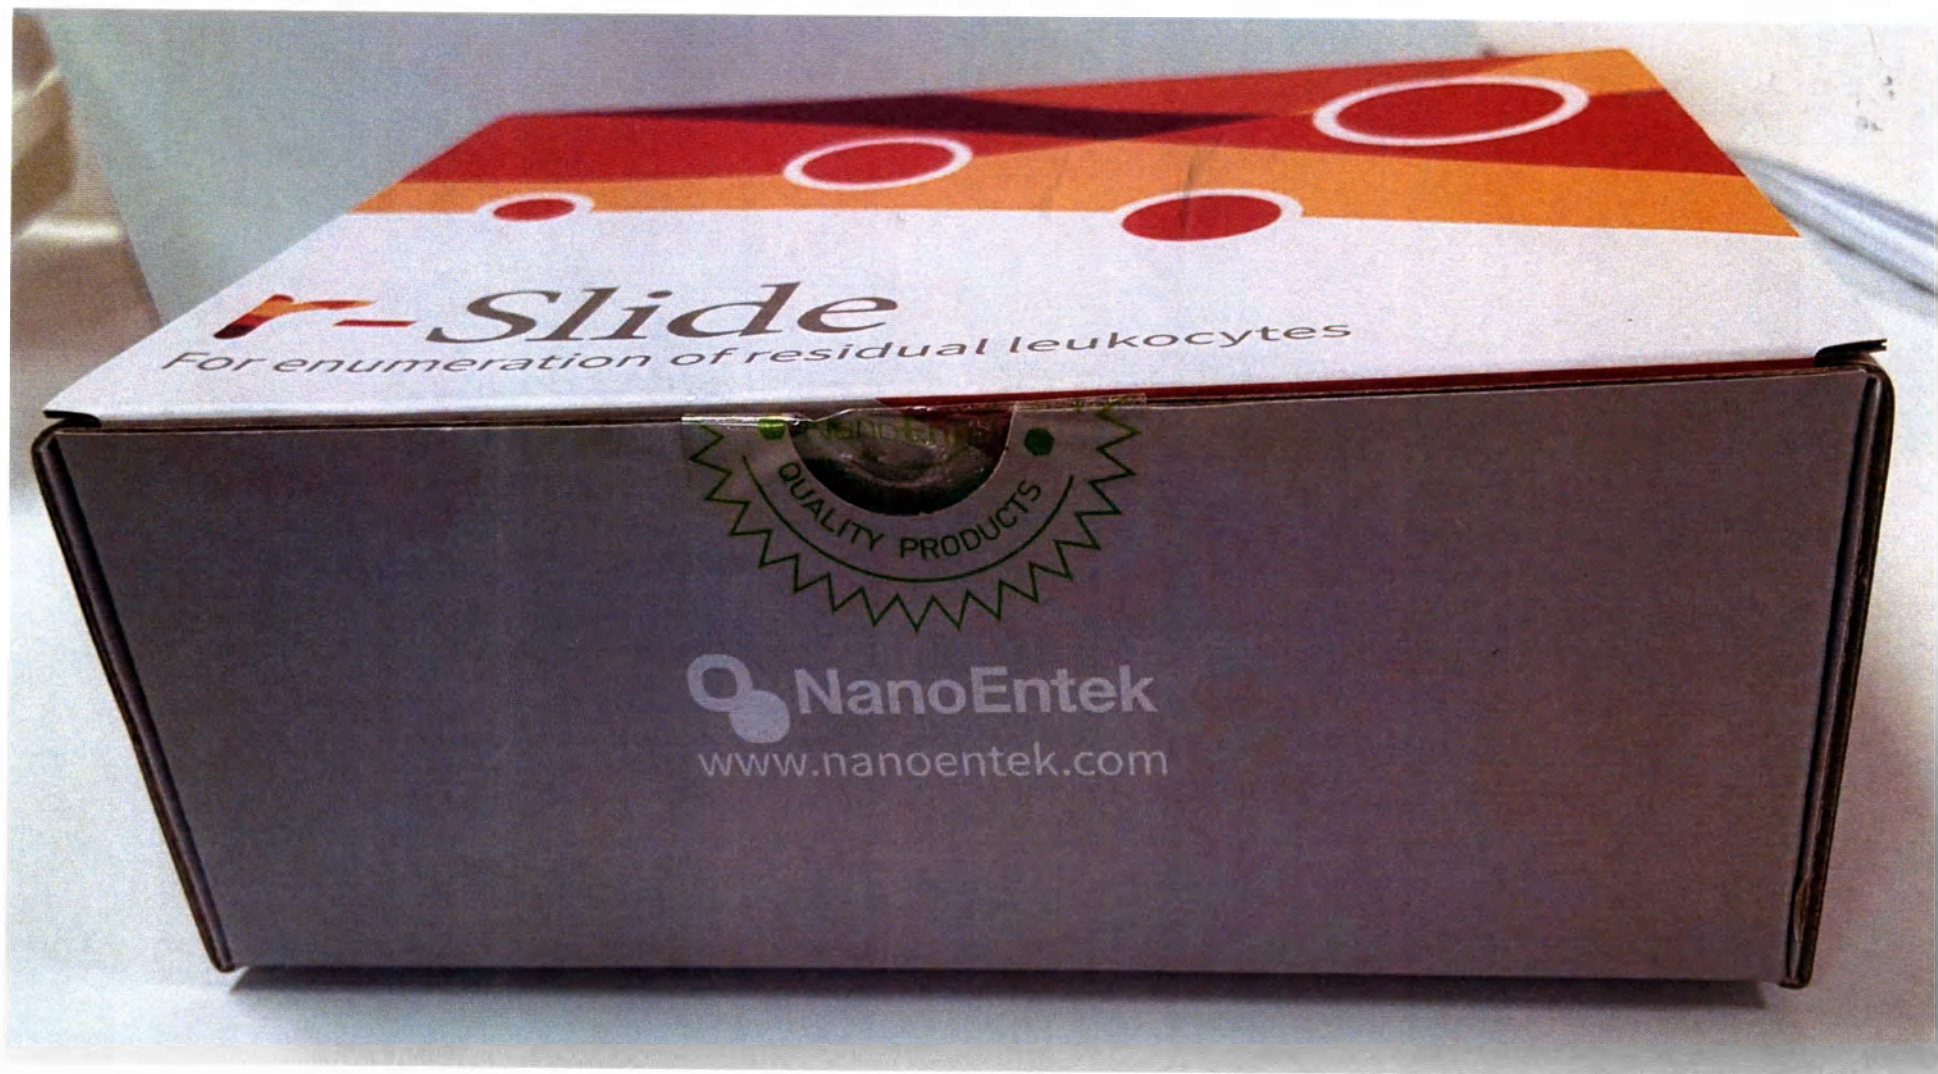

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Вид сбоку.

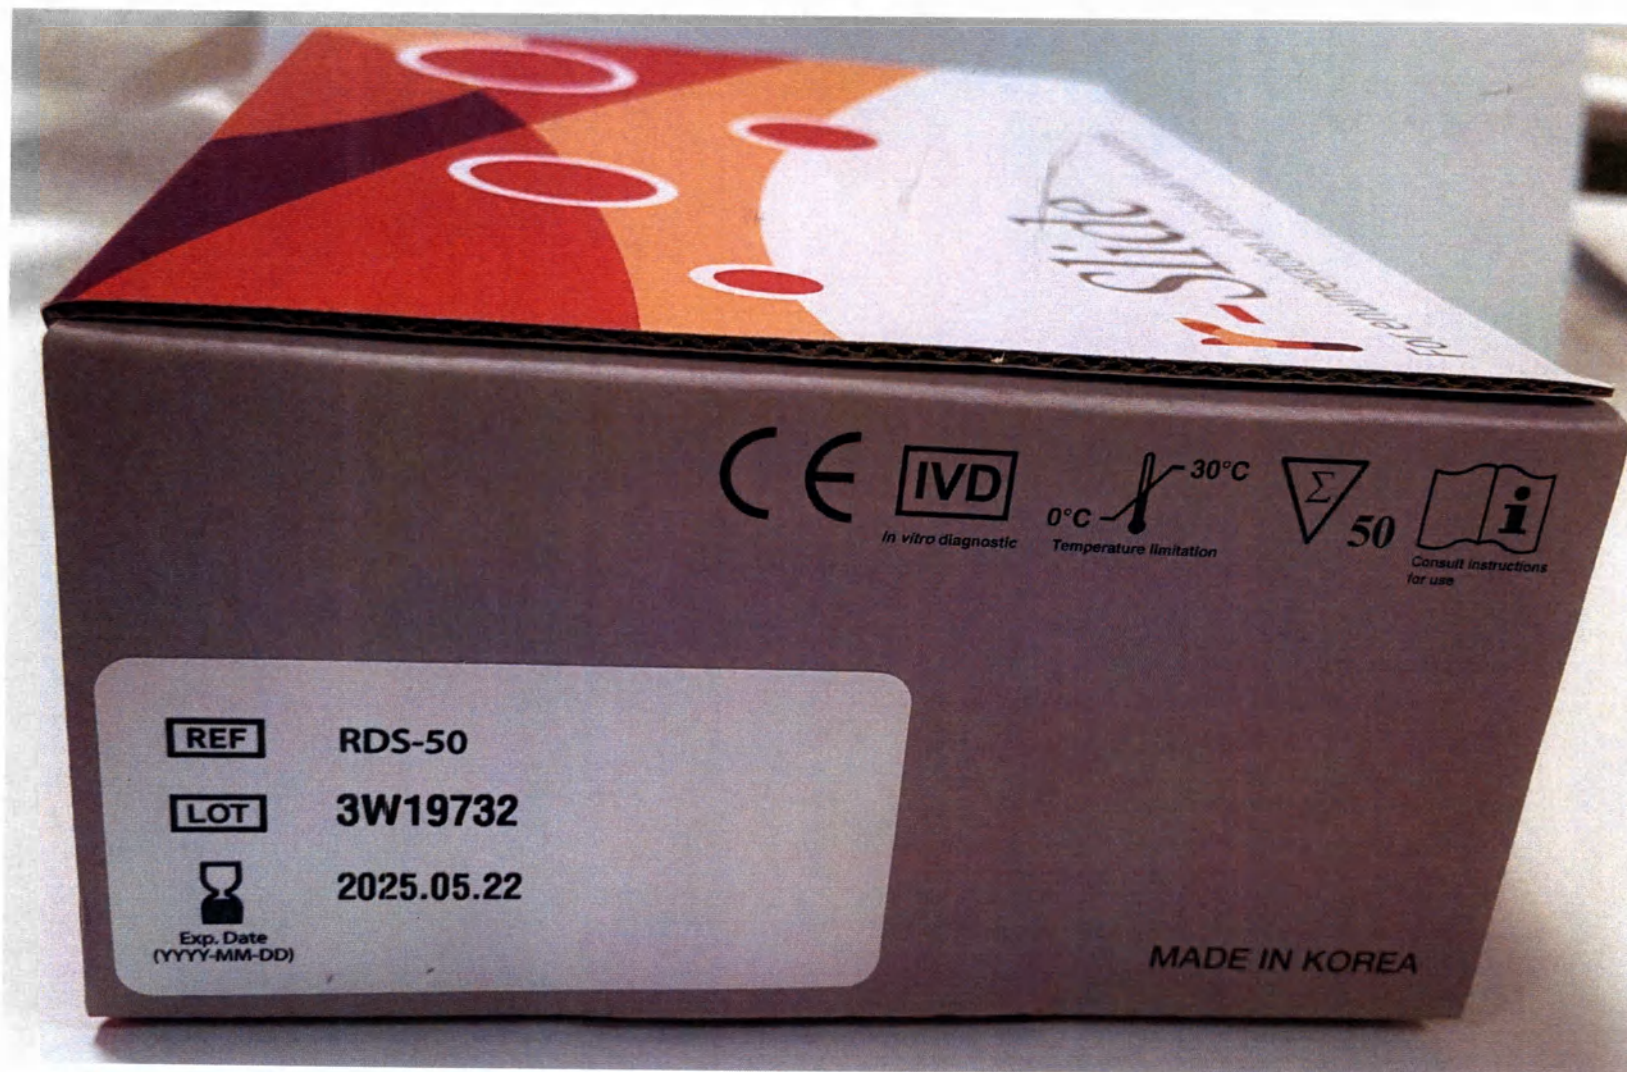

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Вид сбоку.

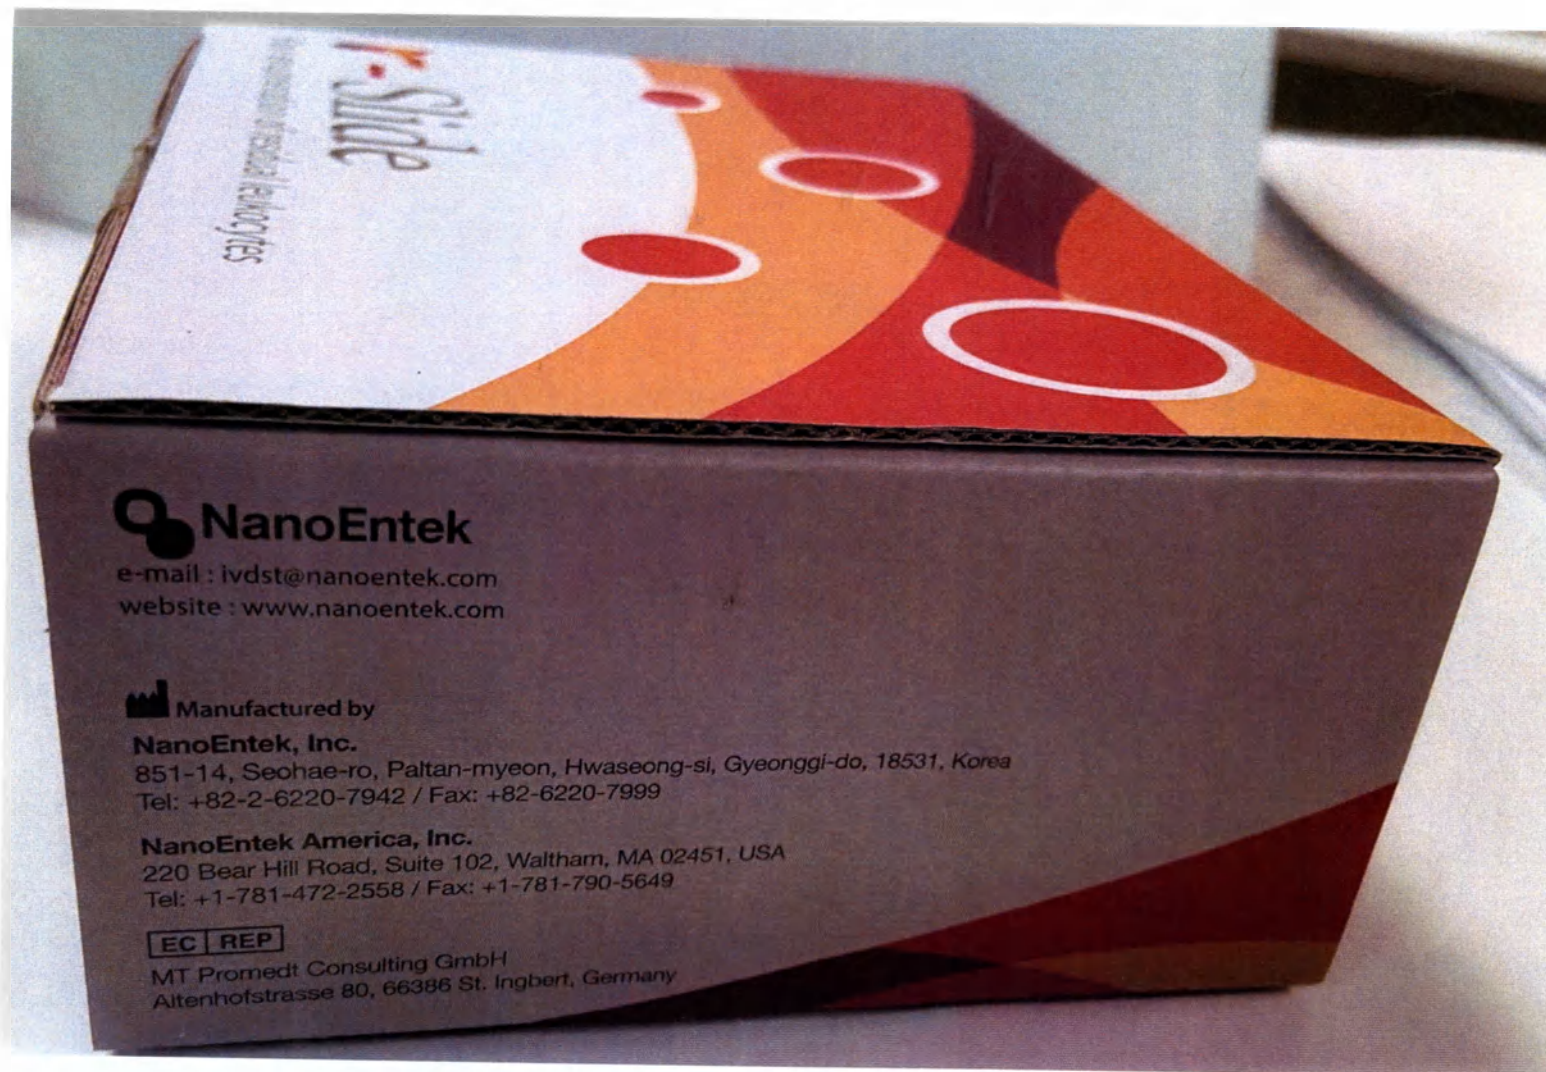

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Вид сзади.



Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide».
Вид внутри упаковки.



Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide». Индивидуальная упаковка.



r-Slide

For enumeration of residual leukocytes

CE


IVD




0°C



-30°C

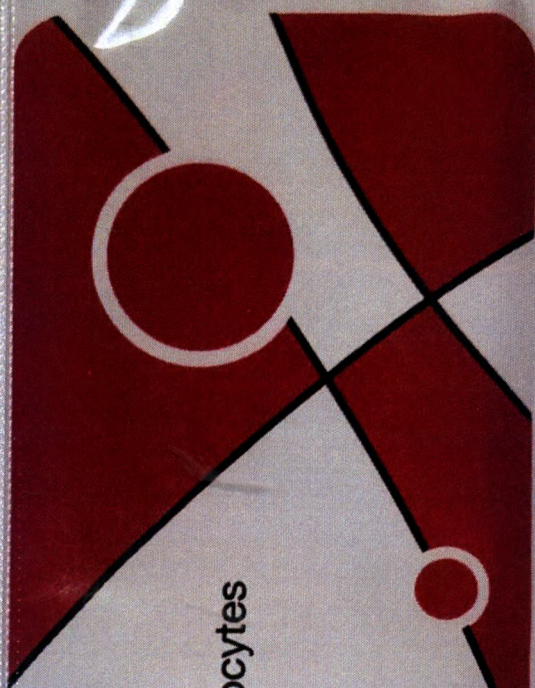

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide».

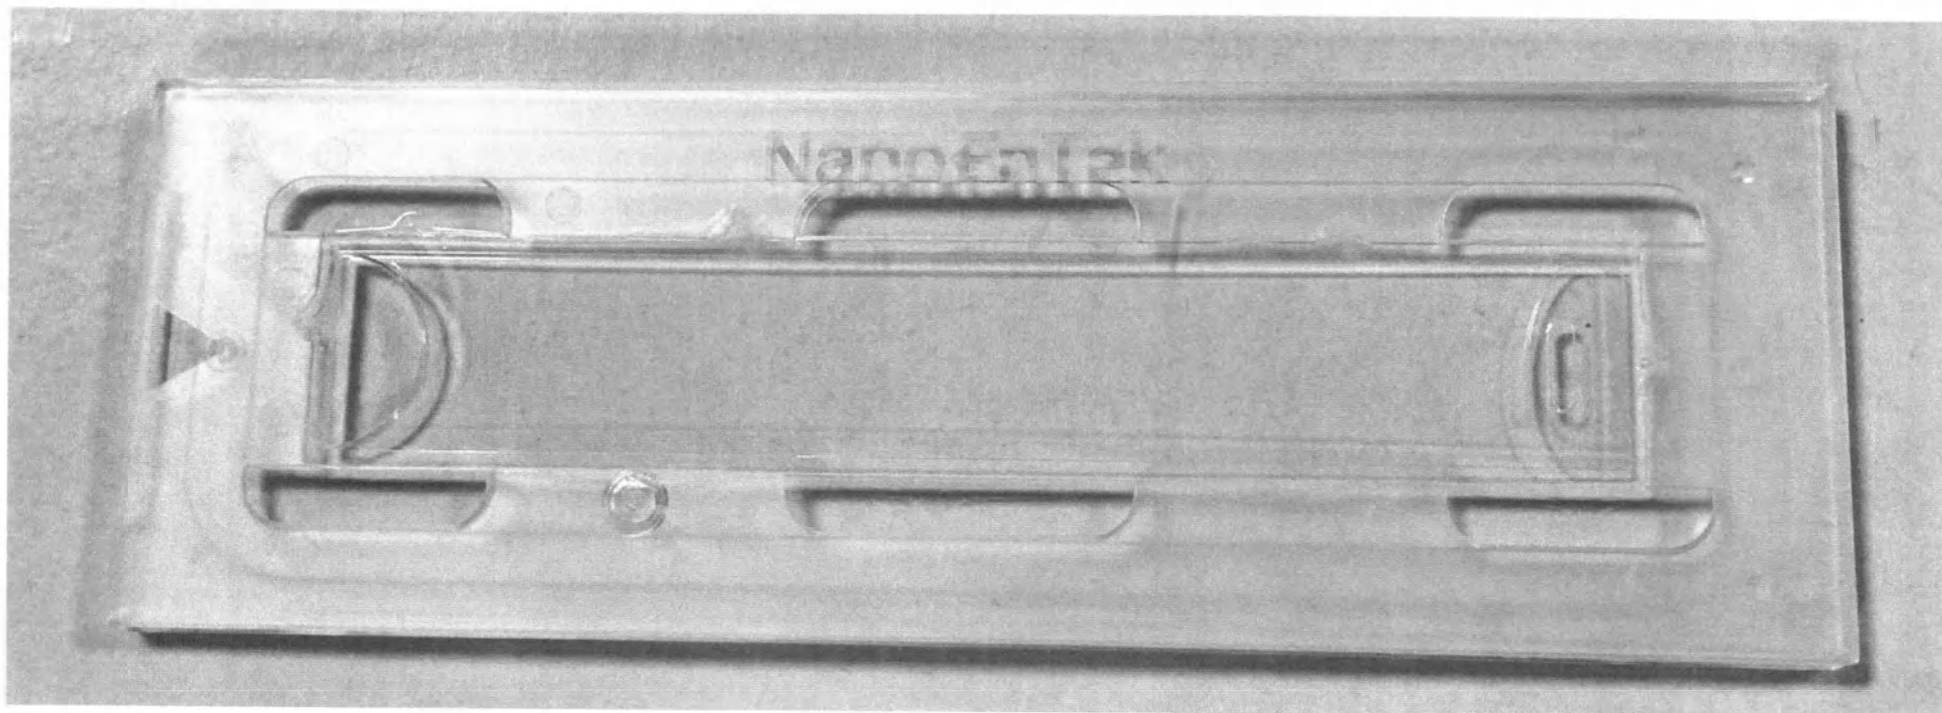

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Стандартный раствор для калибровки прибора «Standard Bead Solution».





Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Раствор для окрашивания лейкоцитов «r-Solution».



Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2. Транспортная упаковка.



Макет русскоязычной маркировки транспортной упаковки

ADAM rWBC kit

Комплект расходных реагентов ADAM rWBC kit к аппарату для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови, модели ADAM-rWBC, ADAM-rWBC2, в составе:

- слайды одноразовые для анализа образца «r-Slide» - 50 шт.,
- раствор для окрашивания лейкоцитов «r-Solution», 25 мл,
- стандартный раствор для калибровки прибора «Standard Bead Solution», 7 мл;
- инструкция по применению.

Номер и дата регистрационного удостоверения:

РУ № РЗН 2015/2883 от _____.____.

REF

RDS-50



22.06.2023

Только для профессионального применения

LOT

3W19732



22.06.2024

Exp. Date
(YYYY-MM-DD)

www.nanoentek.com/ellu.php

IVD



2°C - 8°C

Допускается транспортирование при температуре от 0 до +30°C в течение 21 дня.

Масса нетто единицы потребительской упаковки: _____ Масса брутто _____


Число единиц потребительской упаковки: _____ Масса Нетто _____




NanoEntek, Inc., Republic of Korea («НаноЭнтек, Инк.», Республика Корея, 851-14, Seohae-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18531

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ
Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬРУСКОМ» (ООО «ДЕЛЬРУСКОМ»),
121108, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Фили-Давыдково, Ивана Франко
ул., д. 4, к. 1, этаж 1, комната 34

Инструкция по применению

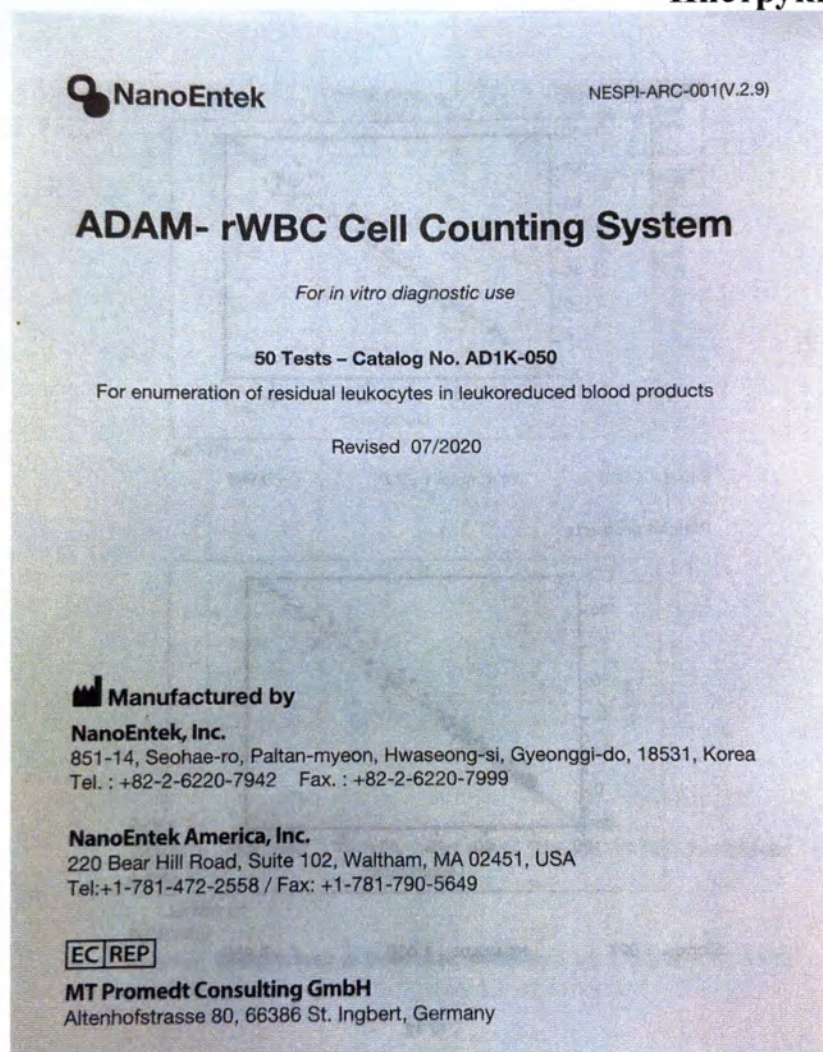

Содержание представлено на английском языке

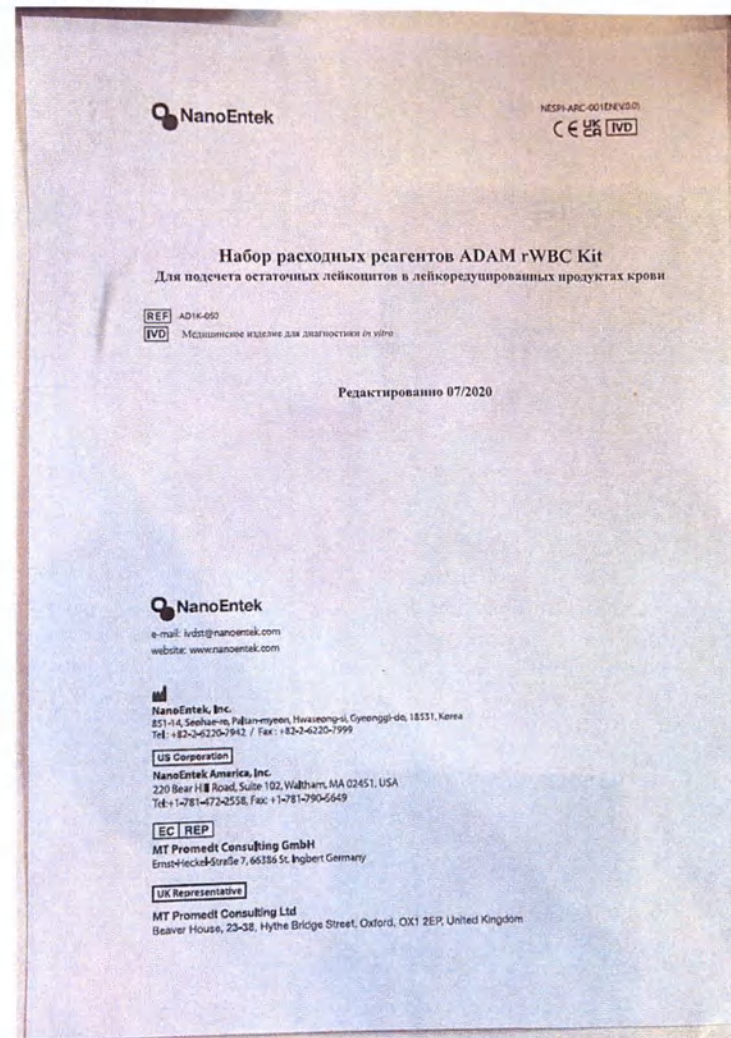

Содержание представлено на русском языке
(внешний вид инструкции по применению может отличаться)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
23 (двадцать три) л.



Директор
ООО «Дельуском»

А. Е. Алёхин

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 188 от 07.09.2023

М В КУЛЯС