

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сысоев Сюн Вэй.
«25» декабря 2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22г
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор калибраторов для количественного определения кальцитонина (СТ) в
клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на
анализаторах серии CL для диагностики in vitro

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001

mindray

CT CAL

UDI



(01)06944904091259 (97)105-008550-A0
(10)2023070111 (99)105-008550-00
(17)240817 (98)AHZ202307011100037

Calcitonin Calibrators

Contents : C0: 1×2.0 mL, C1: 1×2.0 mL, C2: 1×2.0 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com


EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD



0123 2°C



mindray

CT CAL



Calcitonin Calibrators
Калибраторы кальцитонина
Calibradores da Calcitonina
Calibradores de calcitonina
Calibratori di calcitonina
Kalsitonin Kalibratörleri
Calibrateurs de calcitonine



AHZ202307011100037


REF 105-008550-00

LOT 2023070111



2024-08-17

047-039623-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-26582888 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>

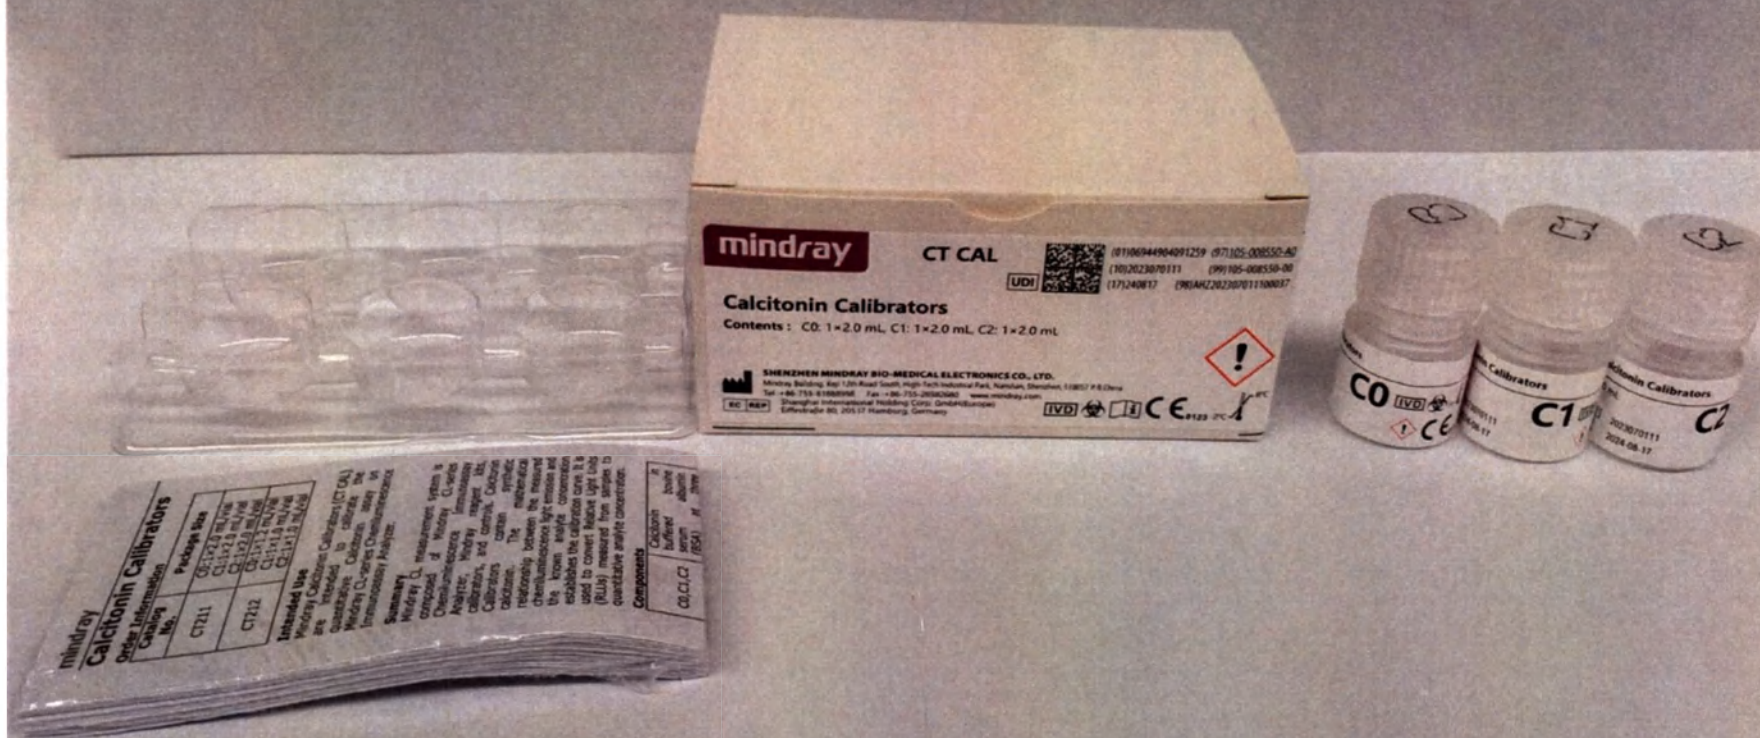


Рисунок 4 Общий вид Набор калибраторов для количественного определения кальцитонина (СТ) в клиническом образце человека
 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 и/или по электронной почте с использованием метода на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

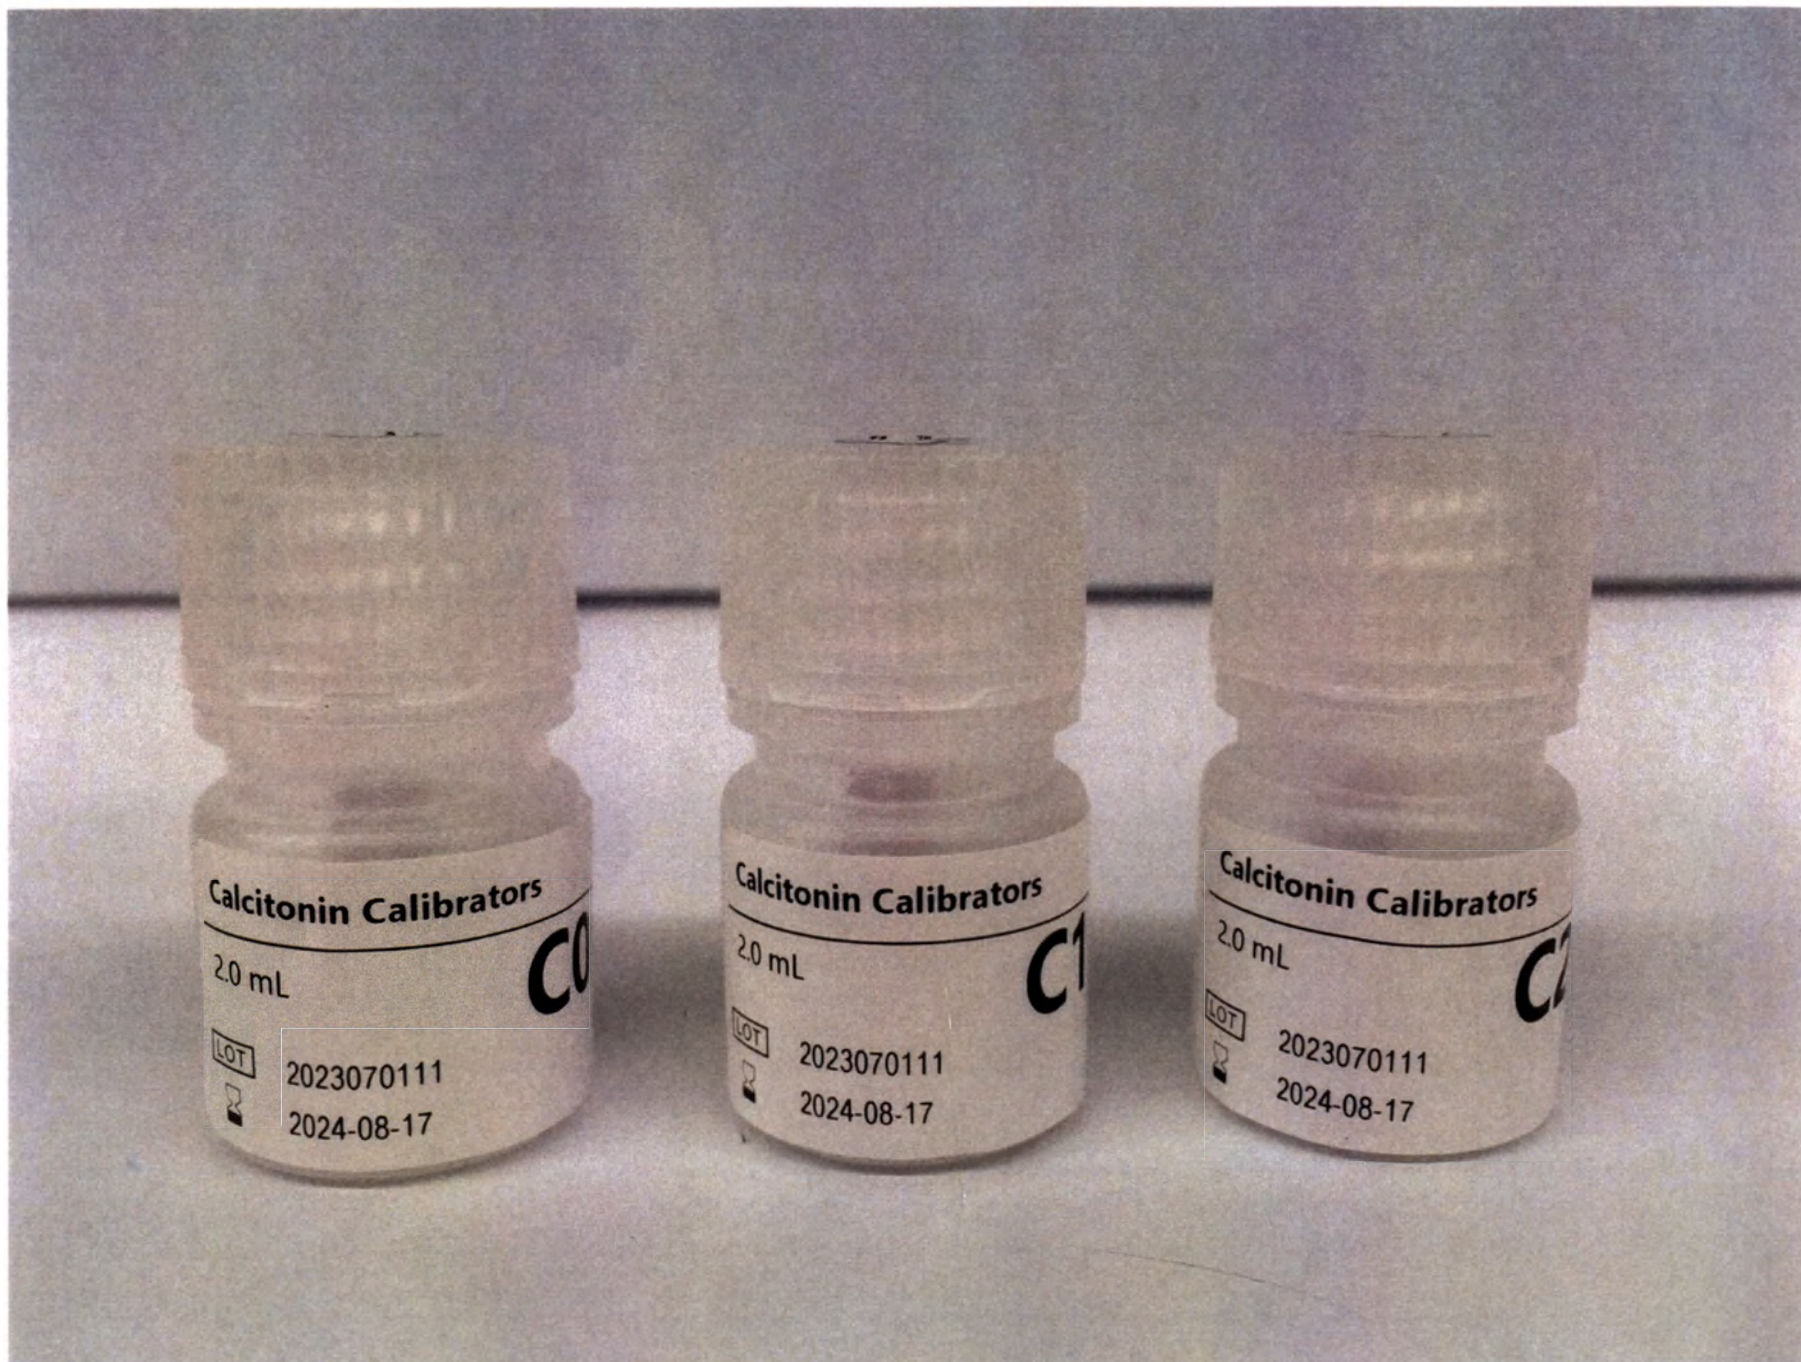


Рисунок 5. Калибратор (C0) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фл. х 2,0 мл (вид 1)

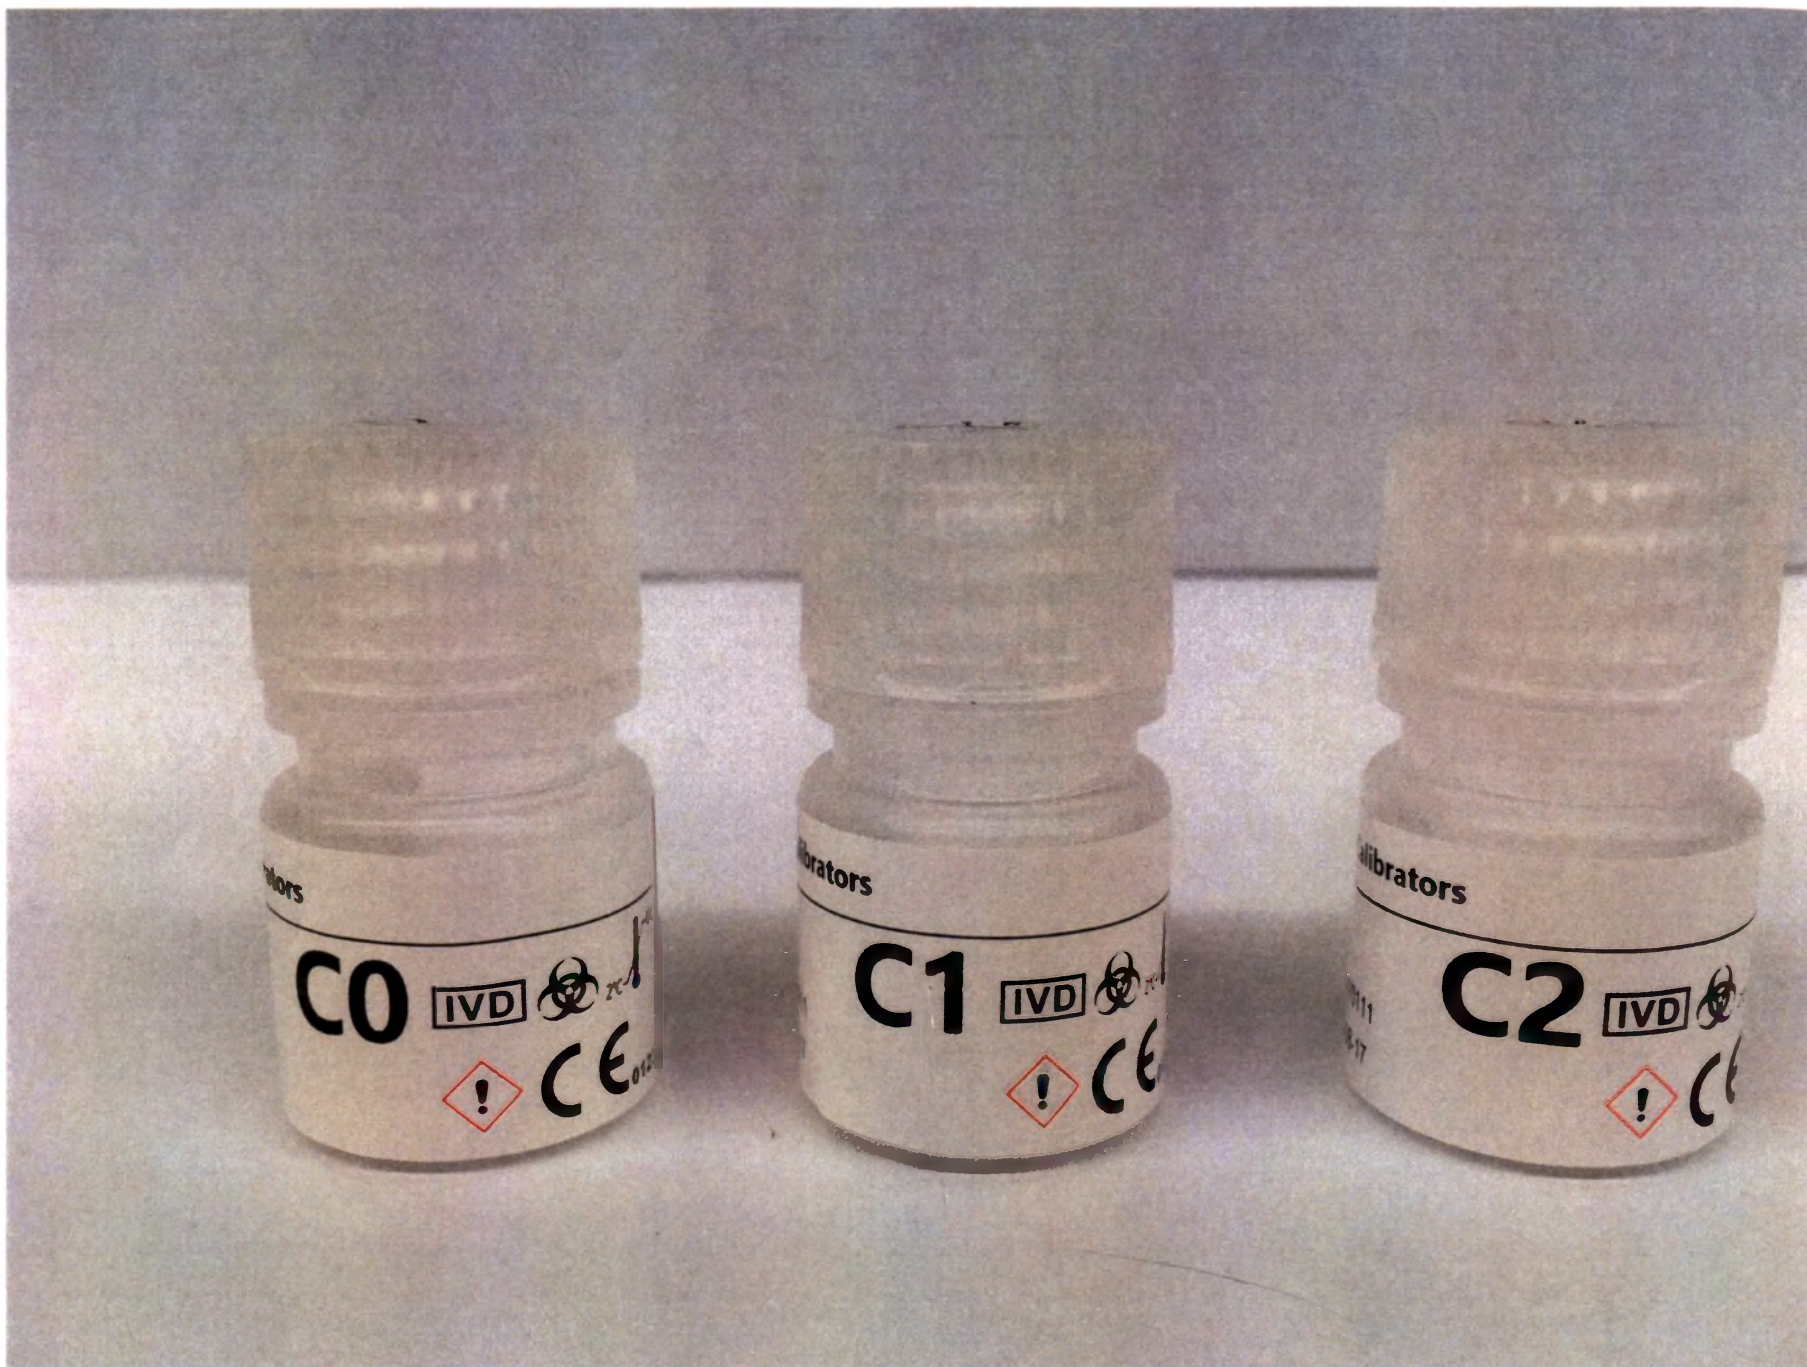


Рисунок 6. Калибратор (C0) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фл. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фл. х 2,0 мл (вид 2)

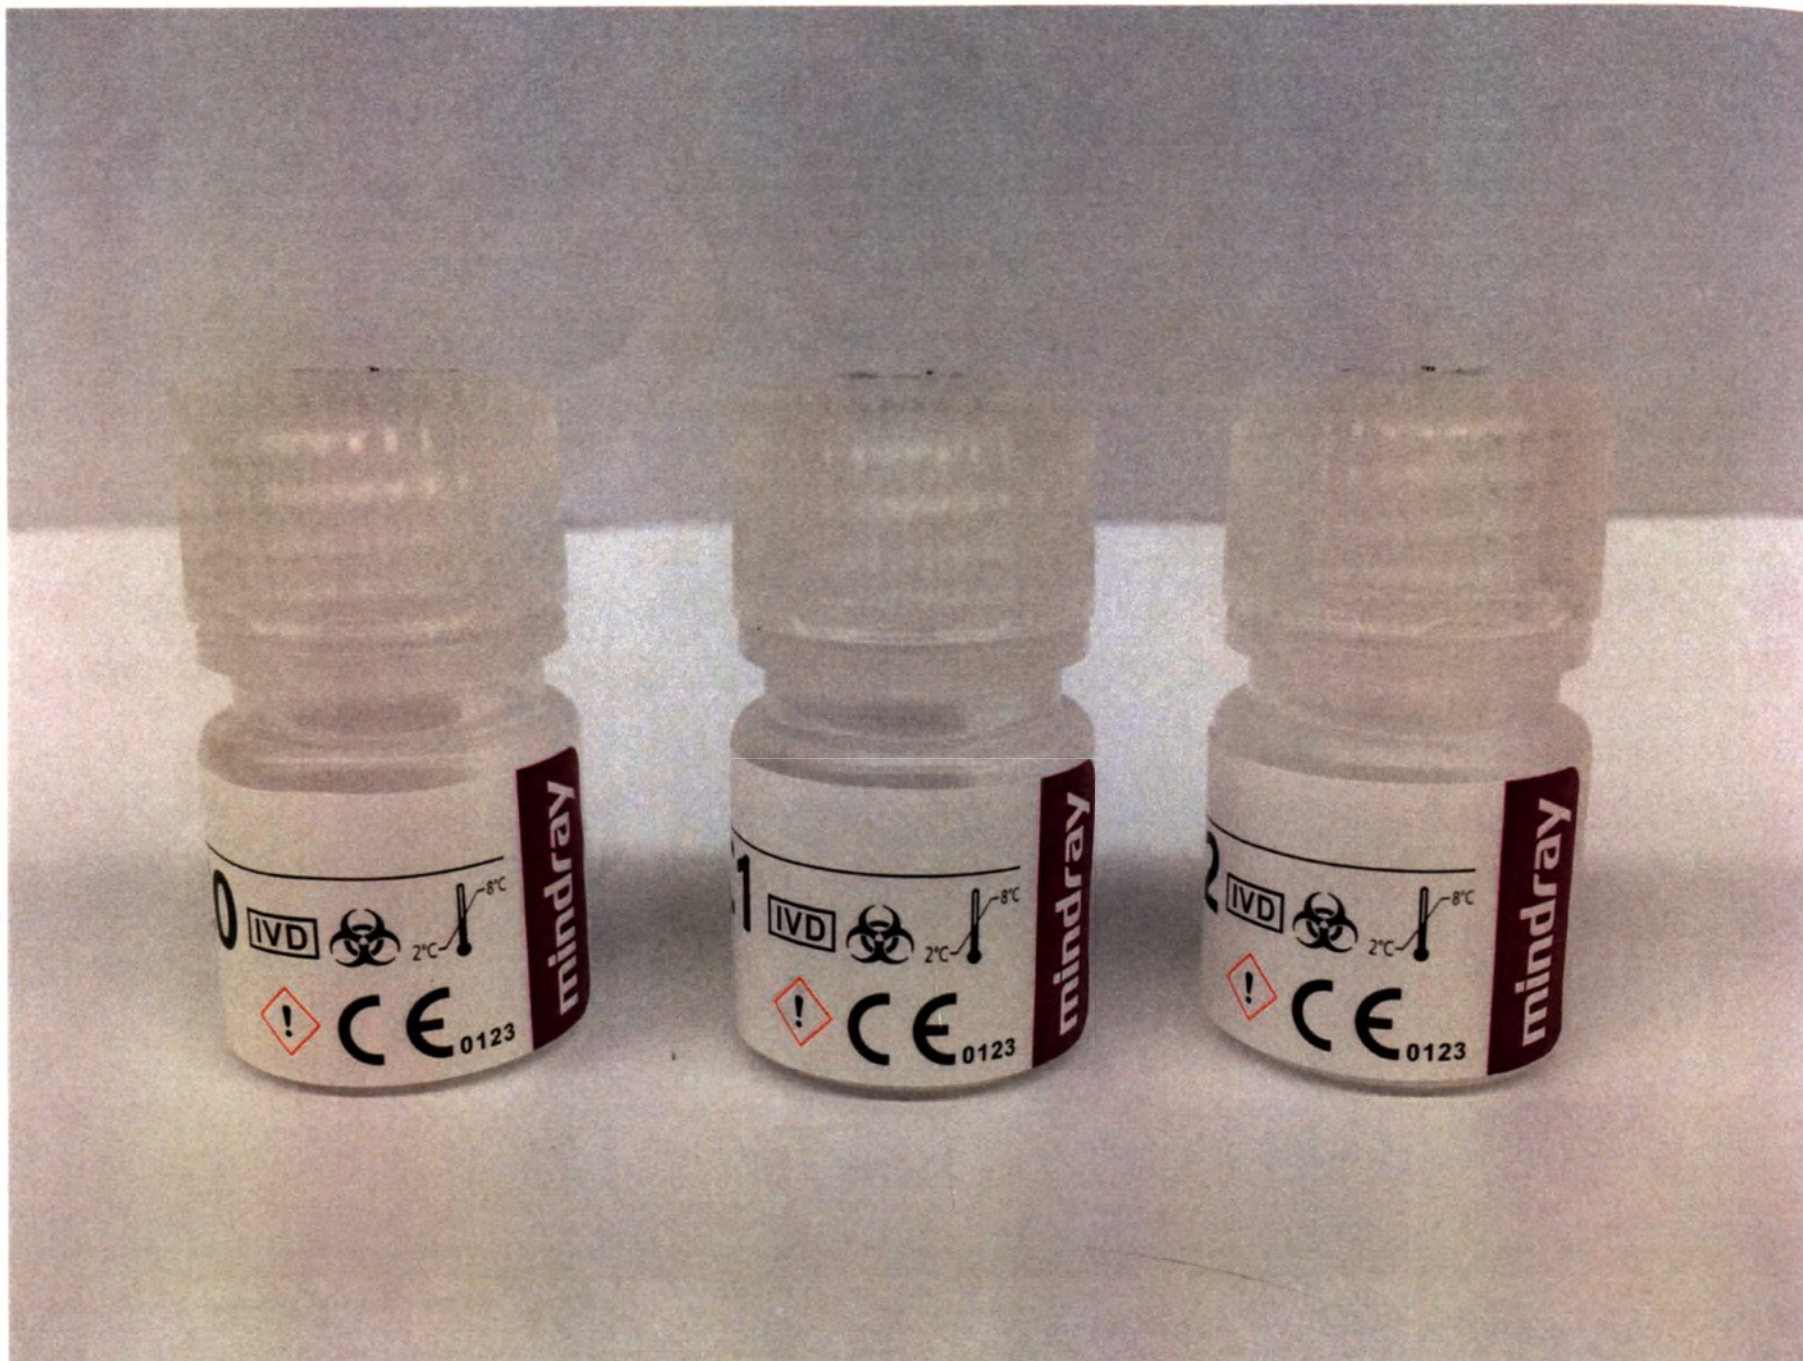


Рисунок 7. Калибратор (C0) – 1 фла. х 2,0 мл; калибратор (C1) – 1 фла. х 2,0 мл; калибратор (C2) – 1 фла. х 2,0 мл (вид 3)



Рисунок 8. Инструкция по применению – 1 шт.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
9 листа (ов)

