



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО Маркер»


А.П. Антонова

«03» октября 2024 г

Фотографические изображения медицинского изделия

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024


Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4

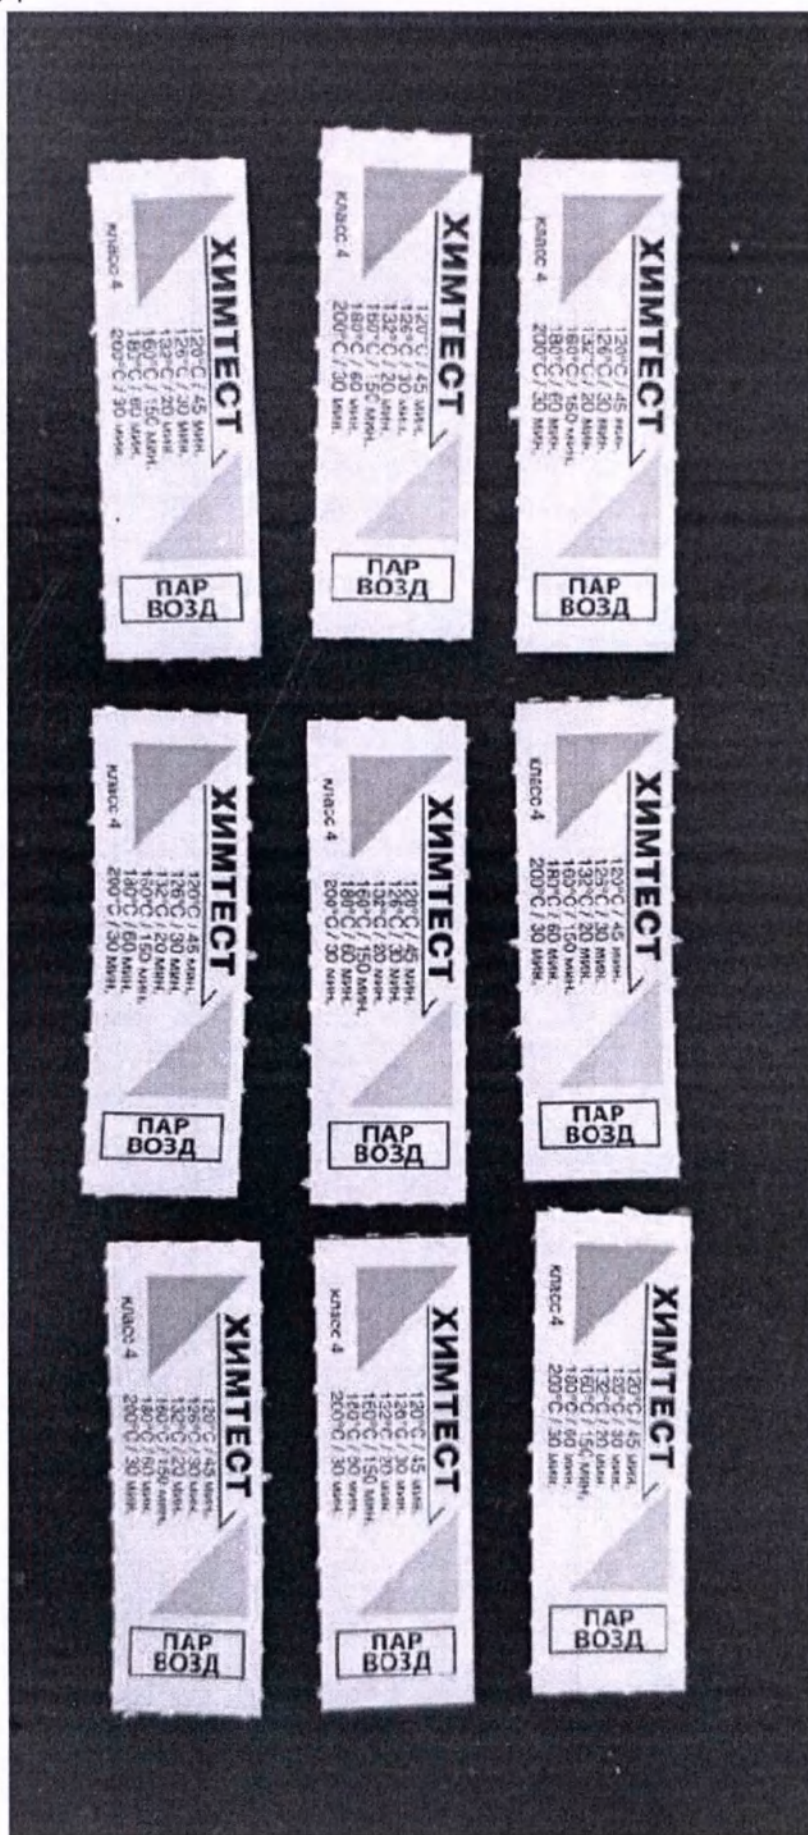


Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4




Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/35мин.; 126°C/20мин.; 134°C/7мин.; 160°C/150мин.; 180°C/60мин.; 200°C/30мин., класс 4

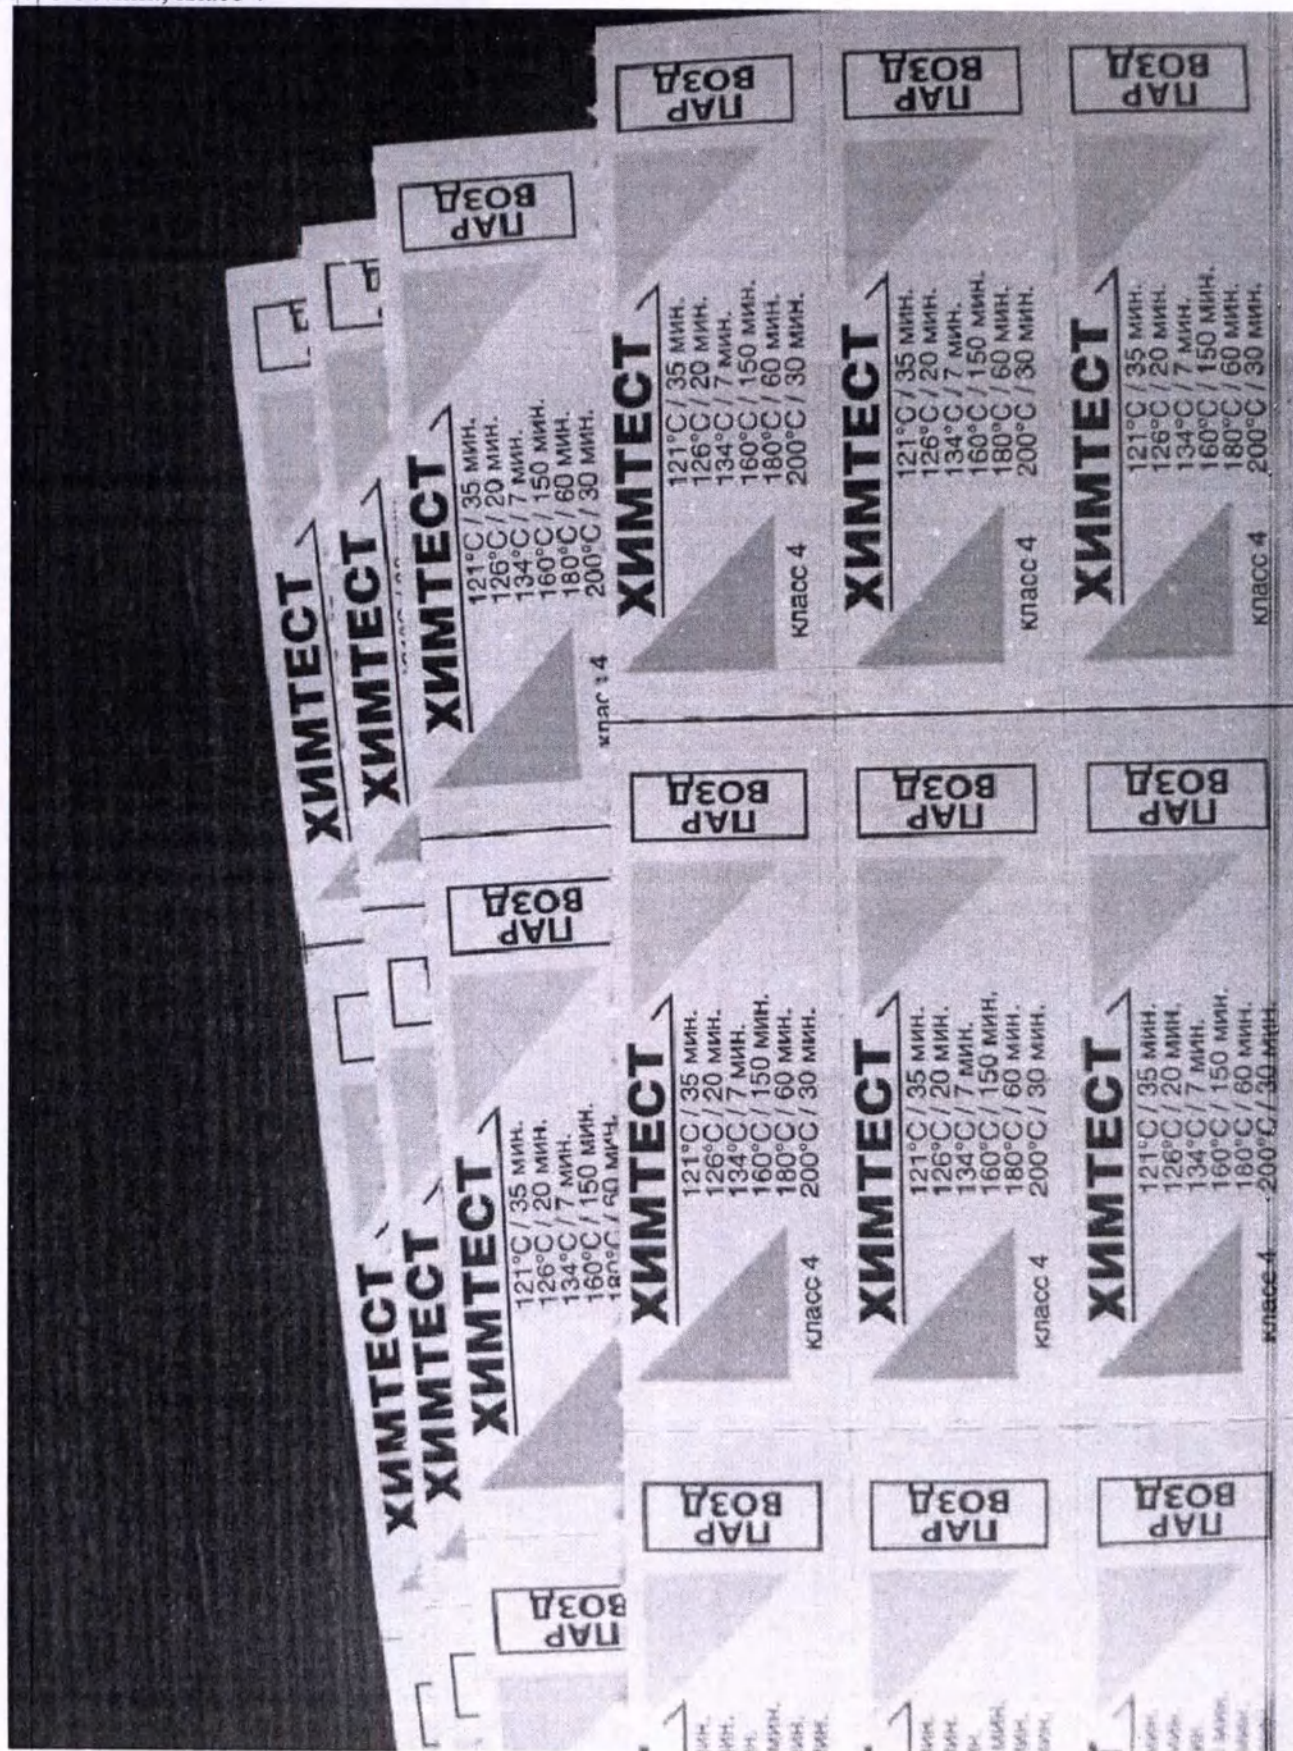

Индикатор химический интегрирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации, обеззараживания и воздушной стерилизации, класс 5

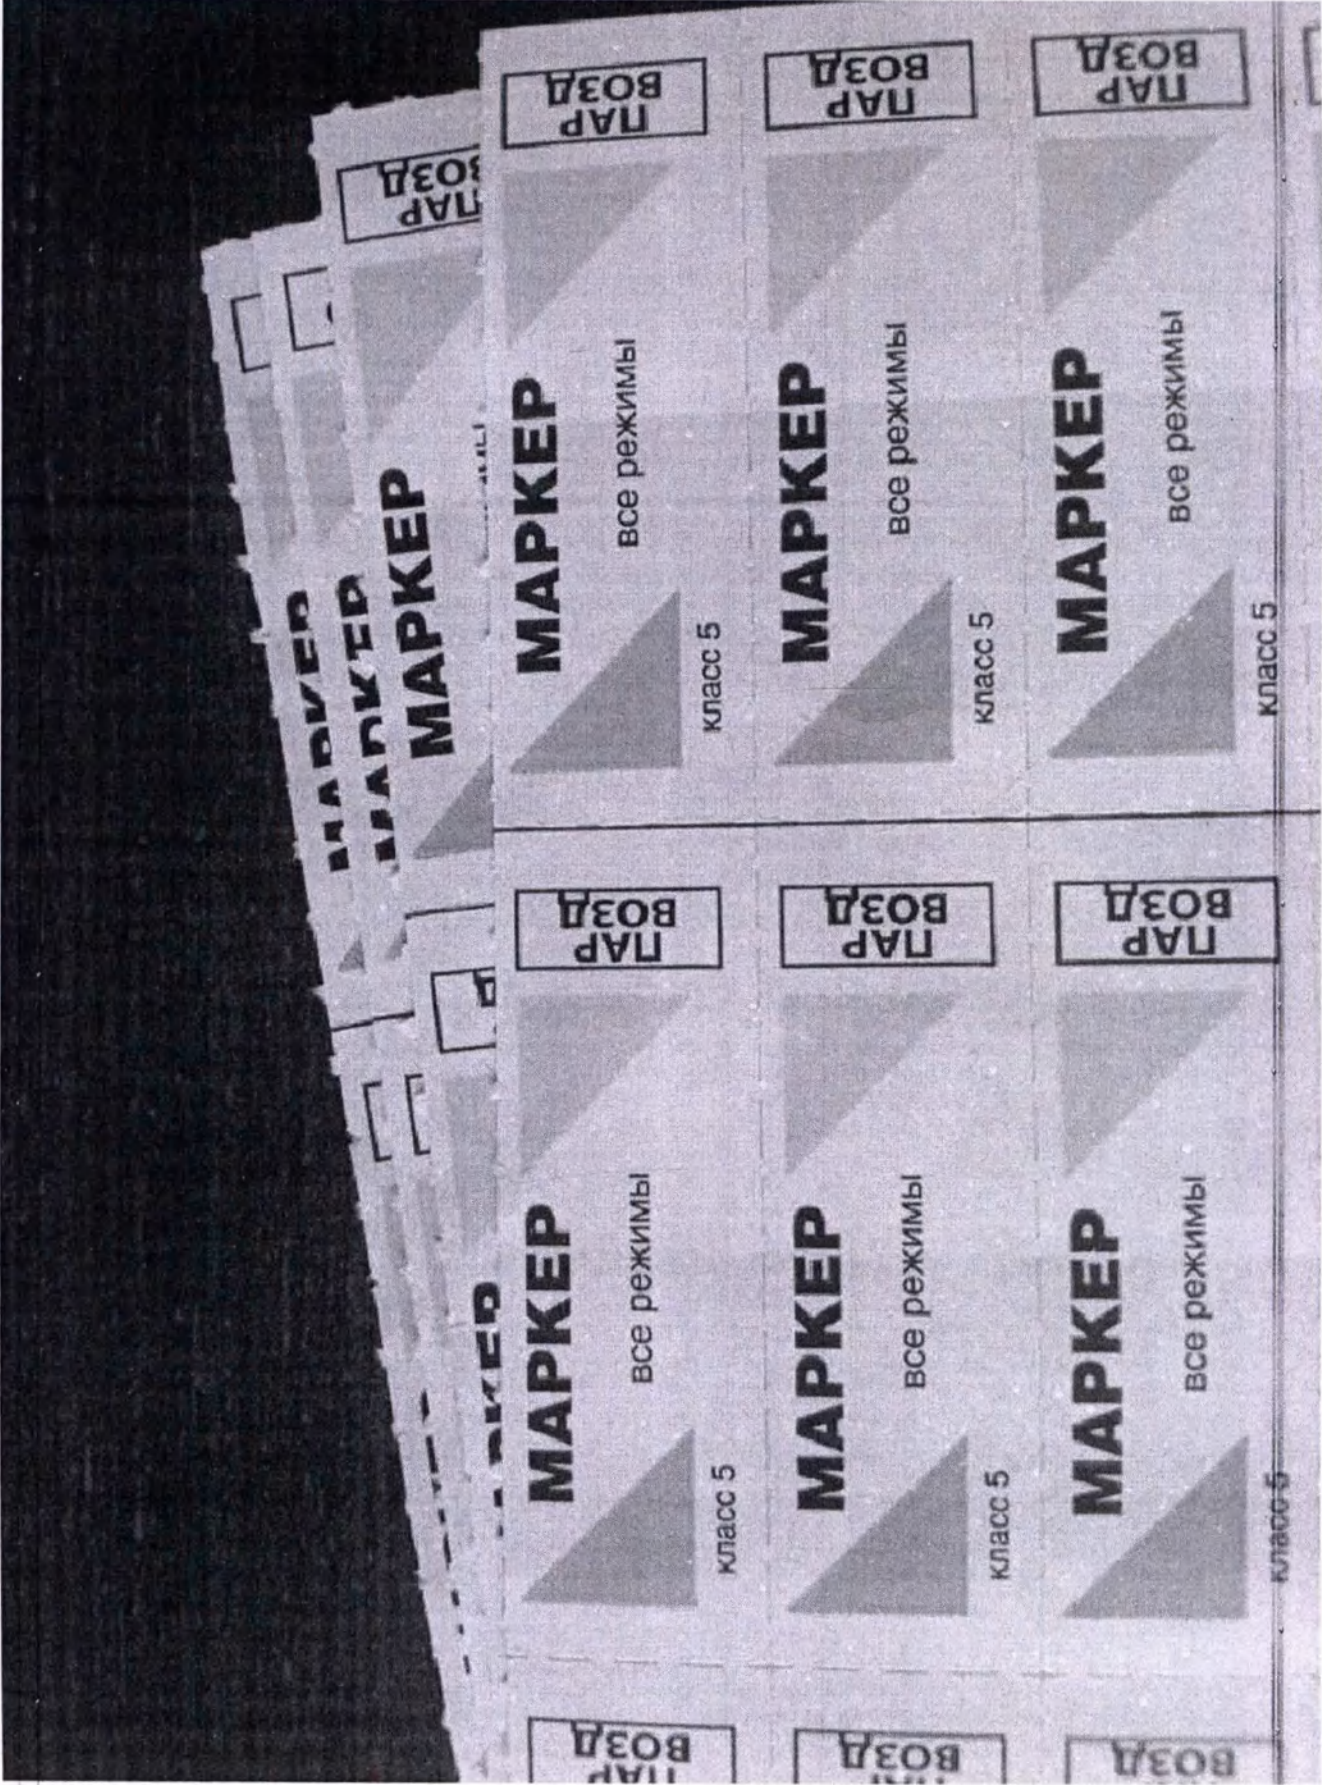

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/180 мин., 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 134°C/18 мин., класс 6

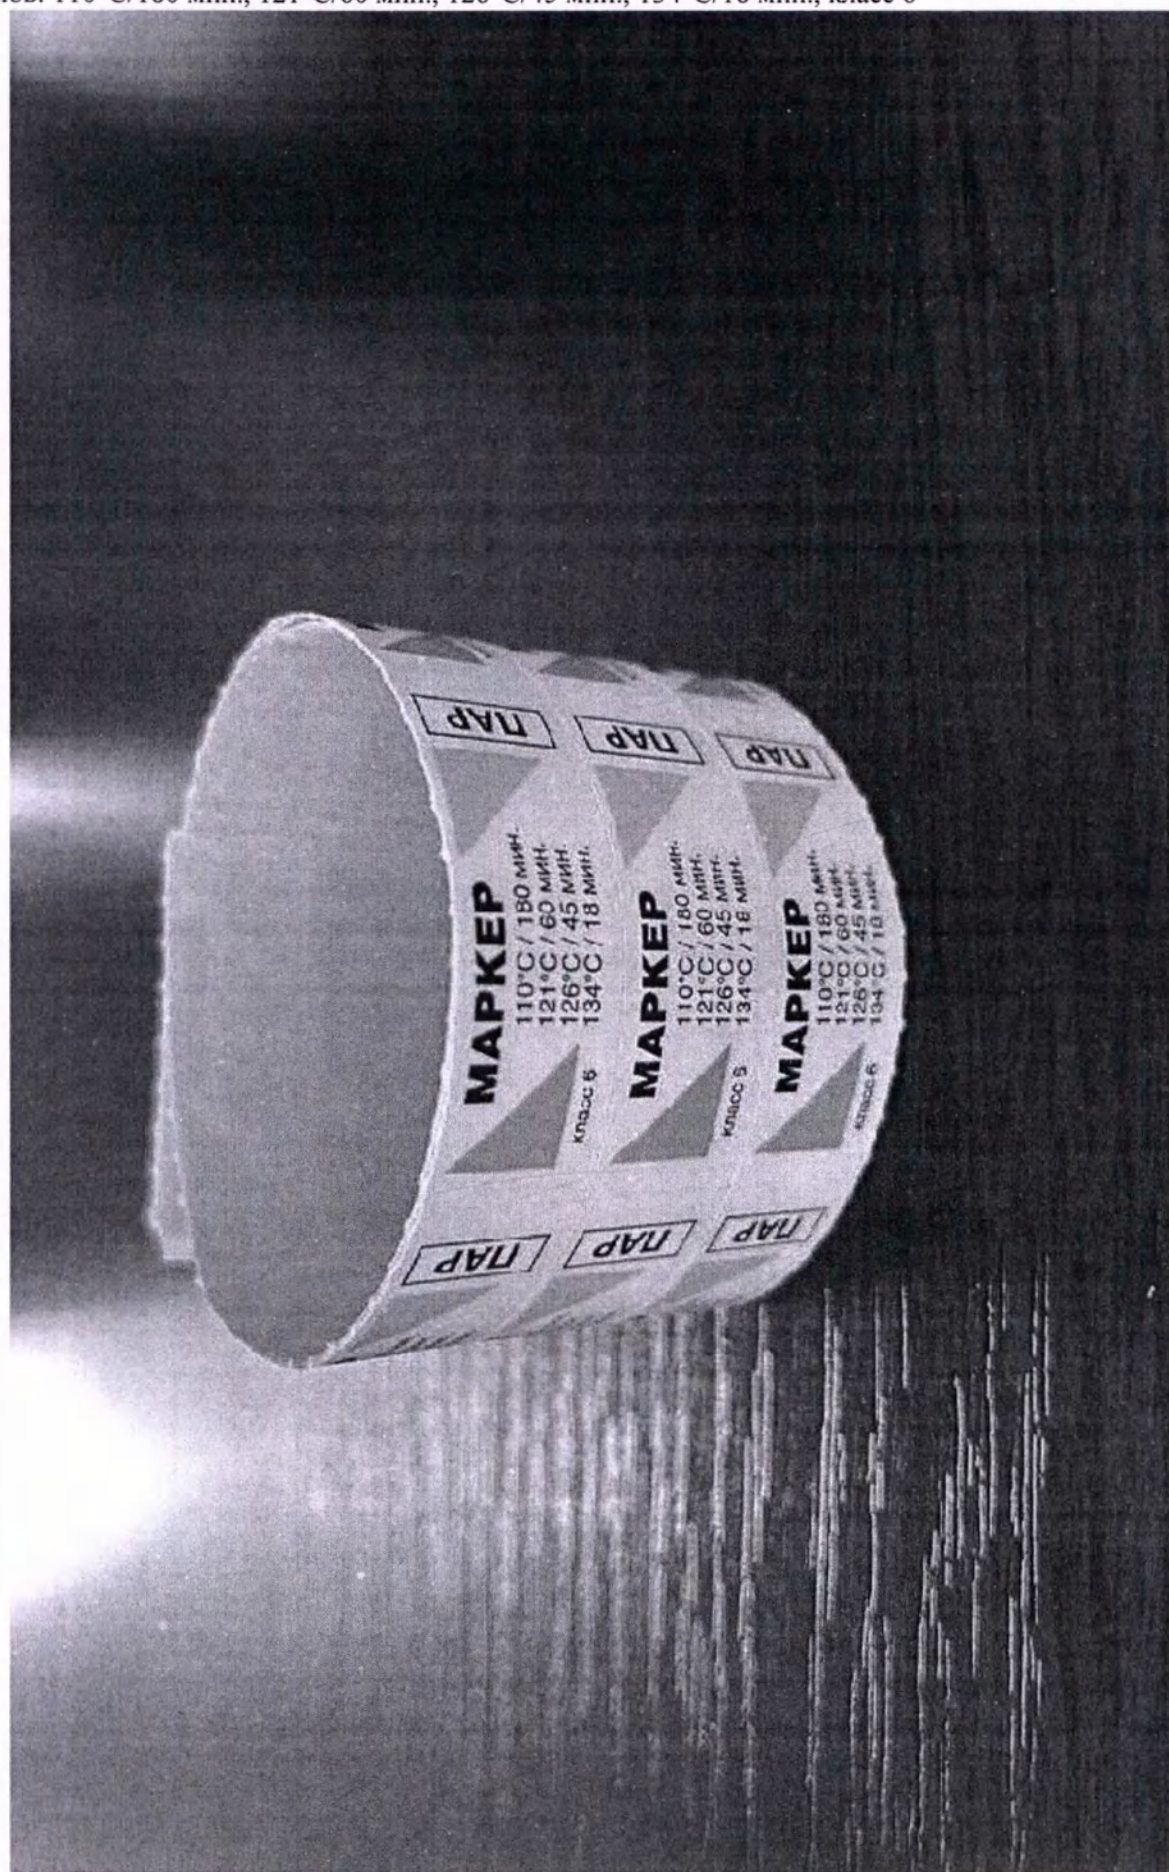

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6



REFERENCES

121°C / 20 мин.
126°C / 10 мин.
134°C / 7 мин.

класс 6

МАРКЕР

121°C / 20 мин.
126°C / 10 мин.
134°C / 7 мин.

класс 6

MAP

MAP

МАРКЕР

121°C / 20 мин.
126°C / 10 мин.
134°C / 7 мин.

класс 6

класс 6

900006

МАРКЕР

121°C / 20 мин.
126°C / 10 мин.
134°C / 7 мин.

Класс 6

МАРКЕР

121°C / 20 мин.
126°C / 10 мин.
134°C / 7 мин.

класс 6

MARTEL

121°C / 20 МИН
126°C / 10 МИН
134°C / 7 МИН

класс 6

MAP


Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6




Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 4




Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6

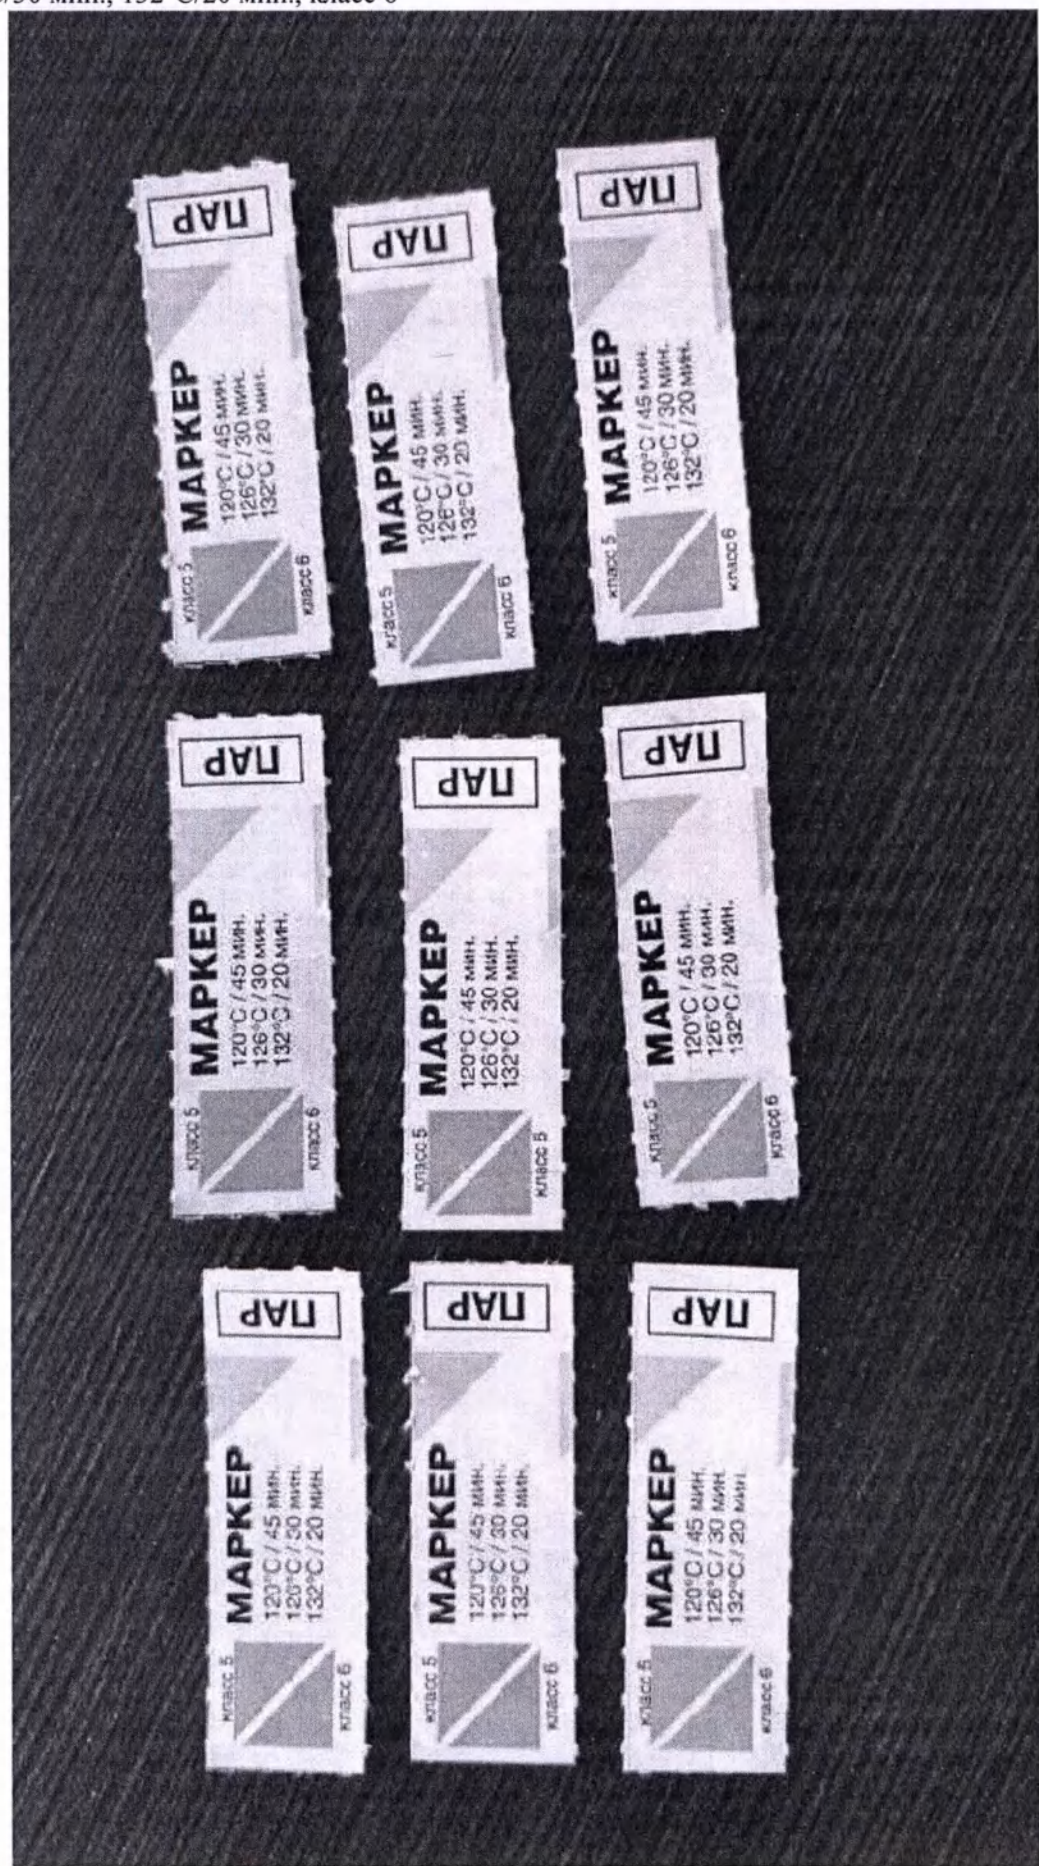

Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6, класс 5

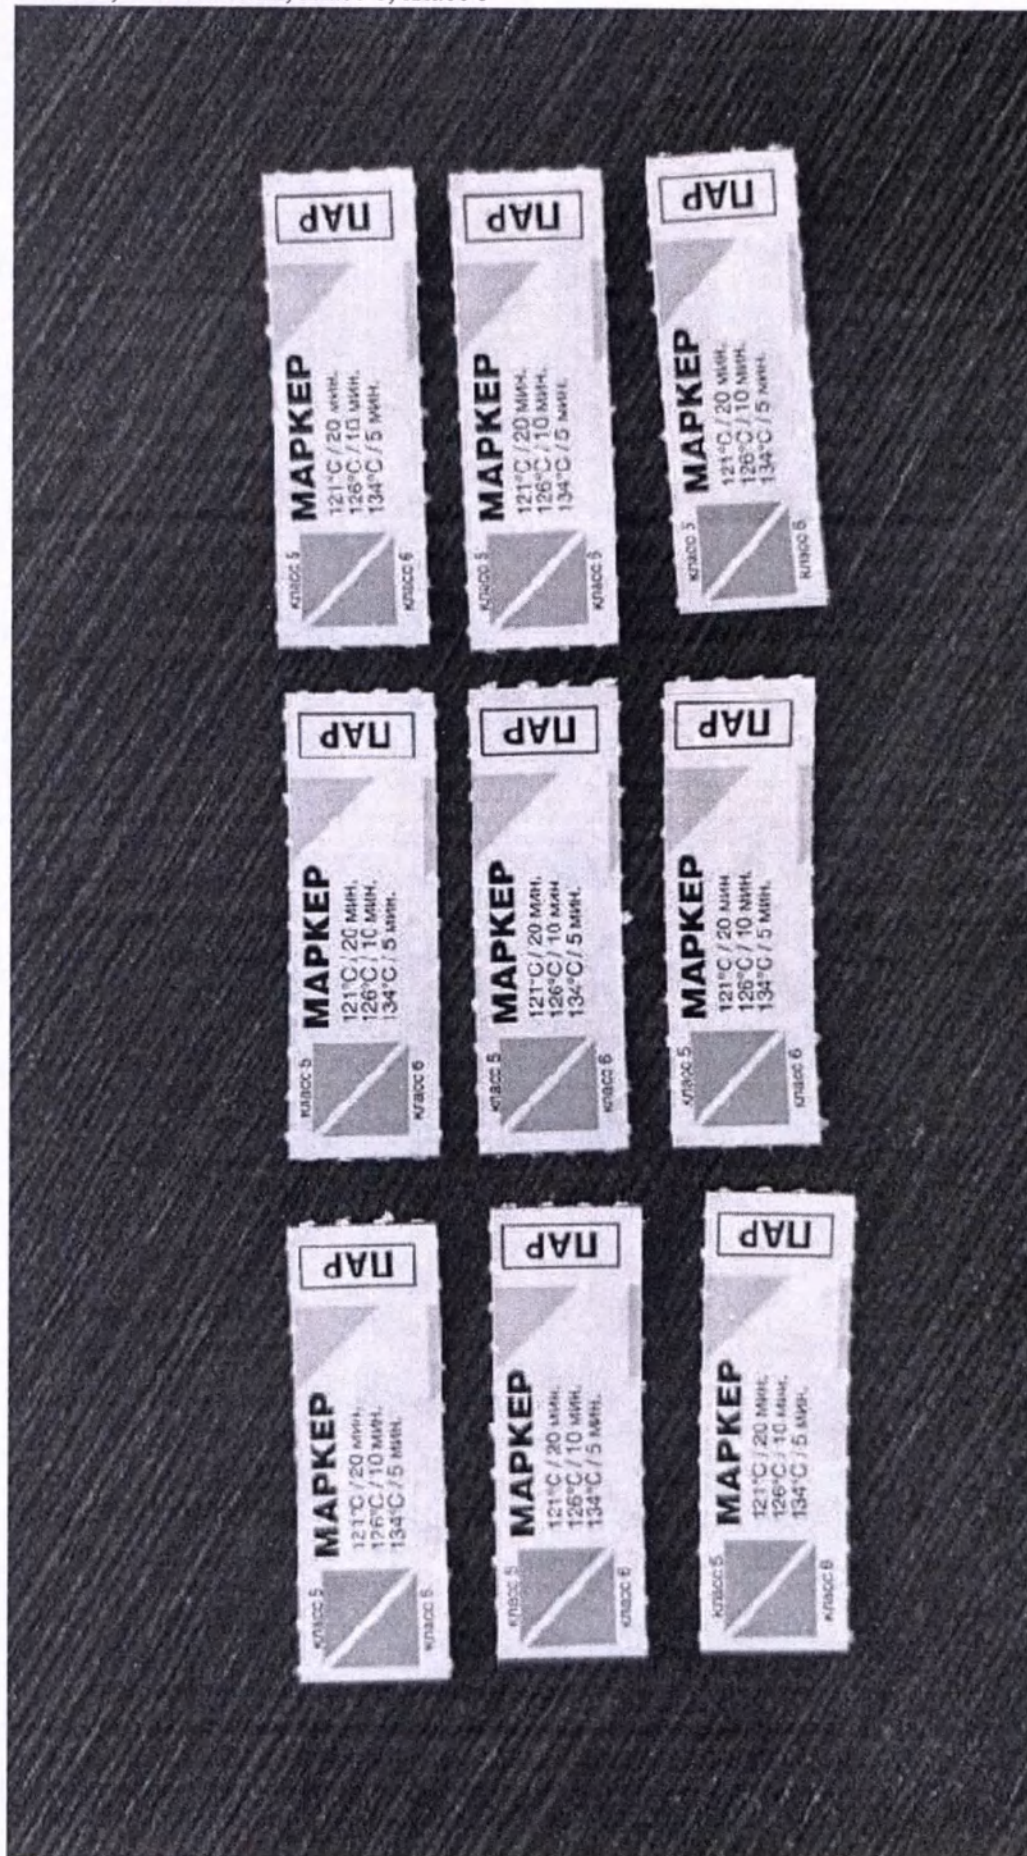

Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов:
160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 5

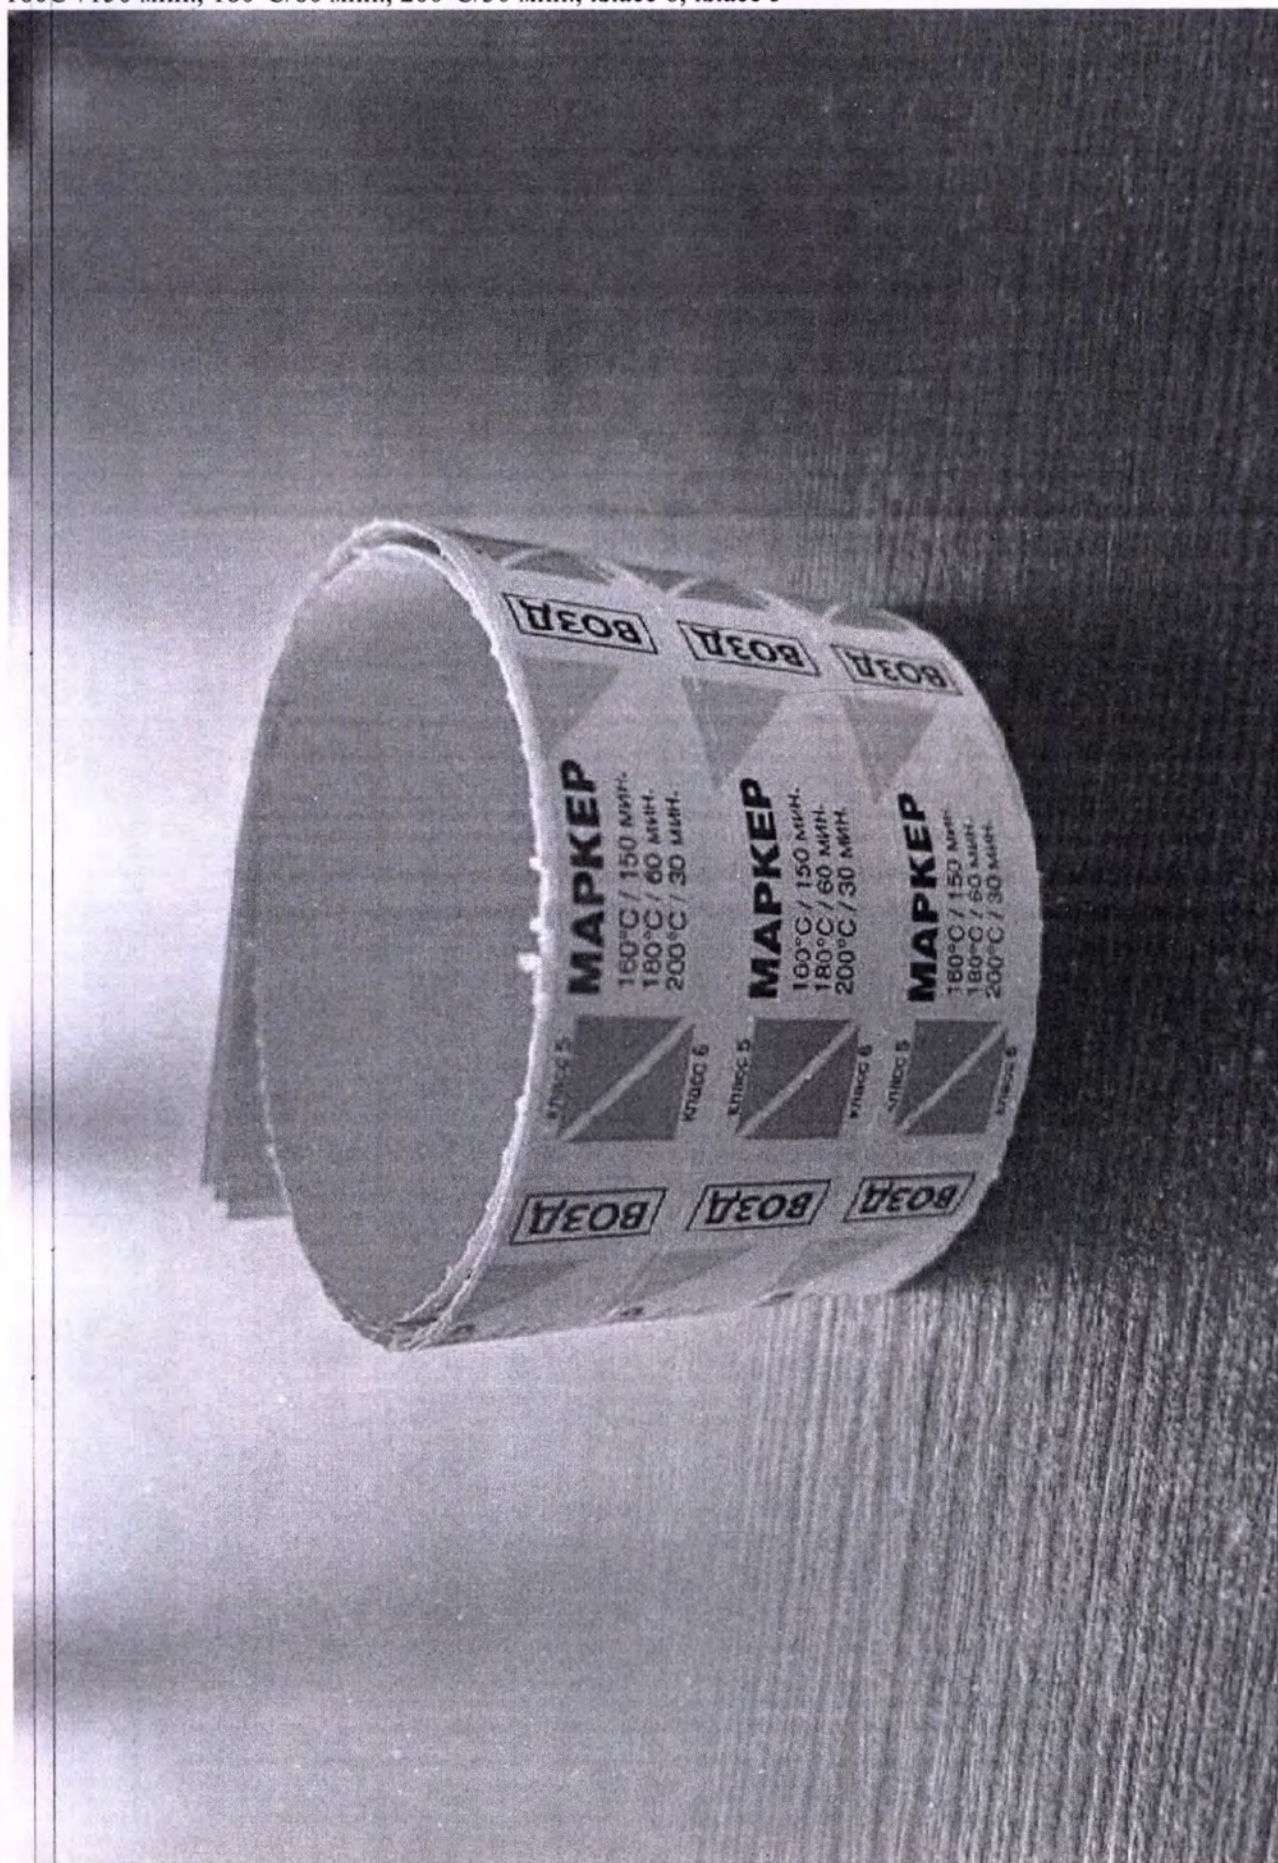

Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-13» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 4



Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации (парового и воздушного обеззараживания) медицинских отходов:


Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-5» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45мин., 120°C/30мин., 132°C/20мин., класс 6



Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-6» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/90 мин., 126°C/60 мин., 132°C/45 мин., 134°C/27 мин., класс 6






Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-7» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6

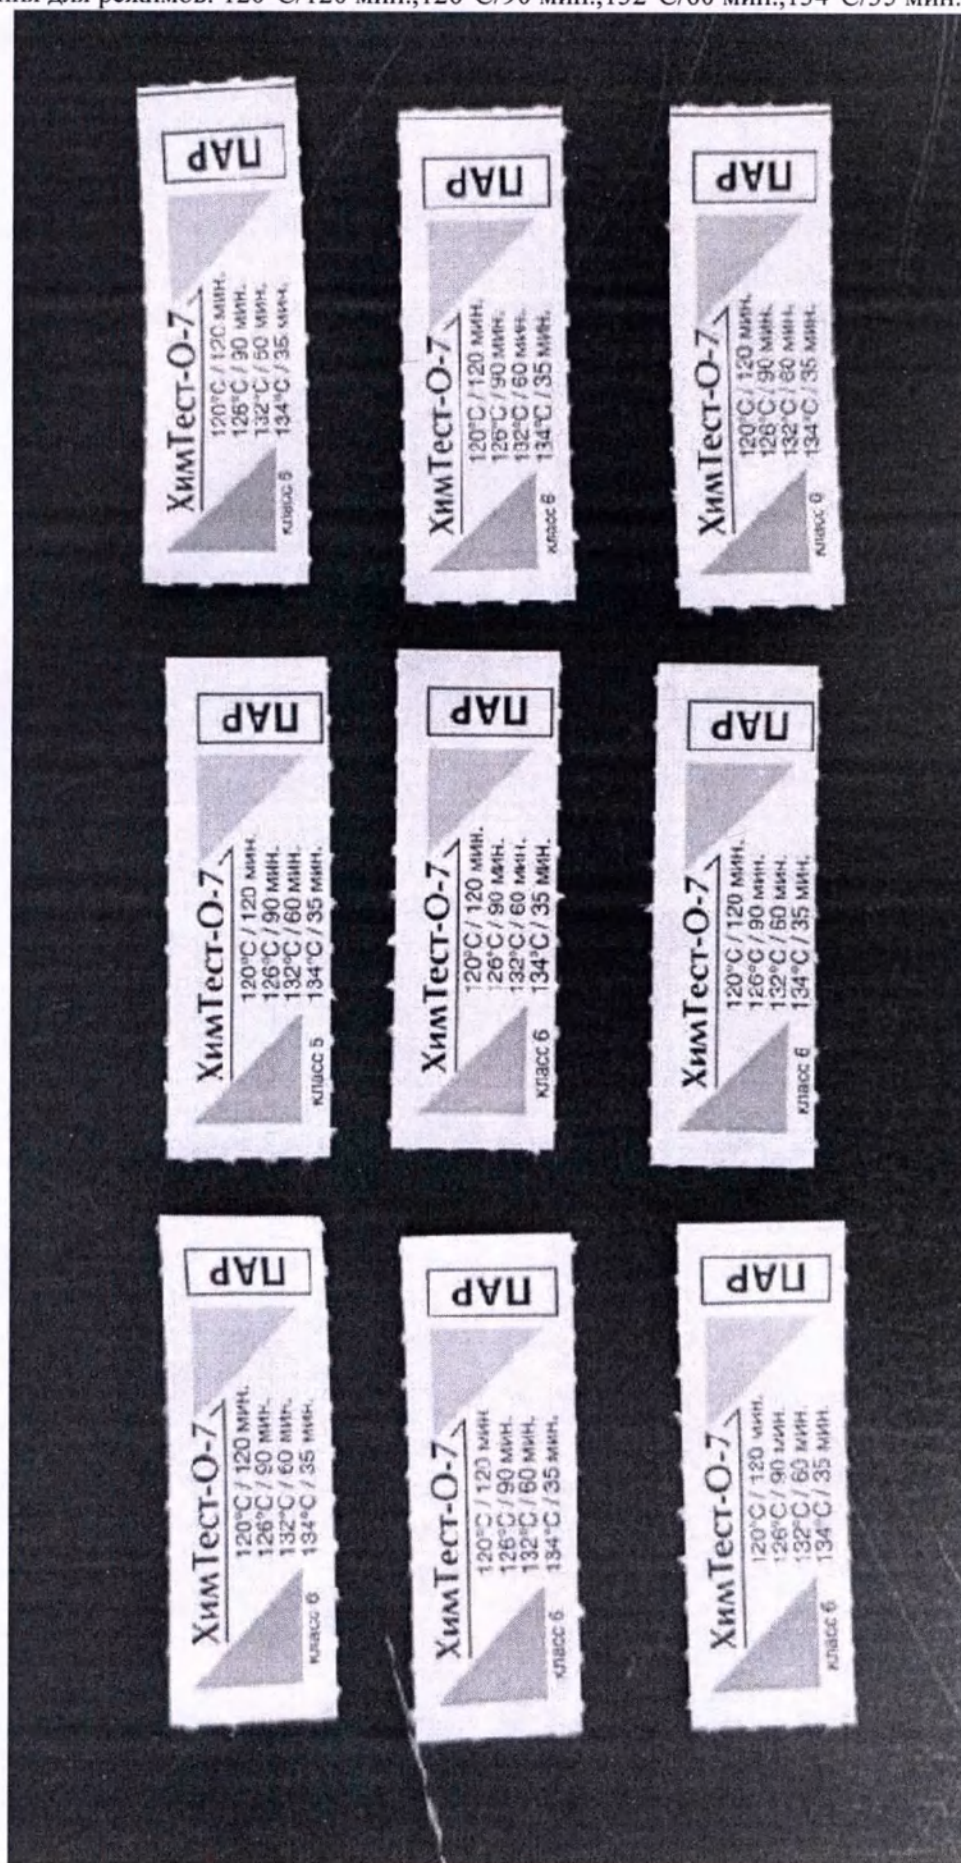

Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-8» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 132°C/90 мин, 134°C/60 мин., класс 6



Индикатор химический «ХимТест-О-9» для контроля параметров воздушного обеззараживания для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 4

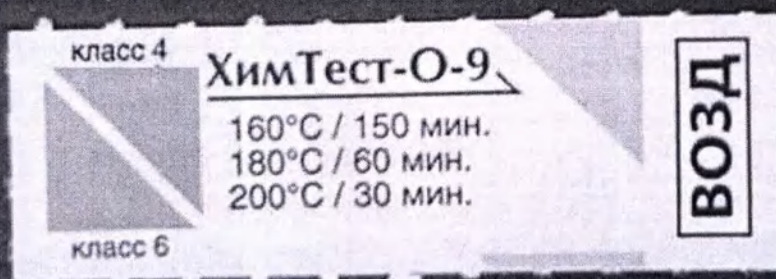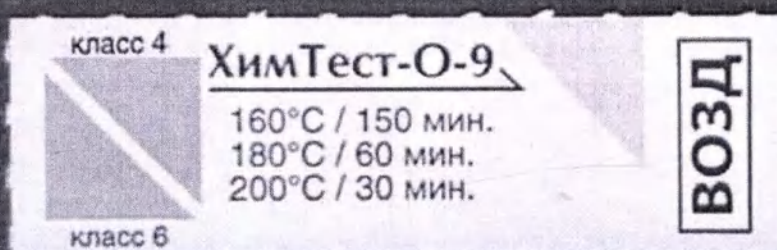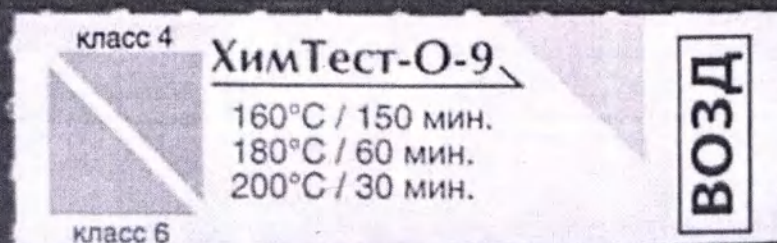


НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МАРКЕР

ЖУРНАЛ

контроля работы стерилизаторов
воздушного, парового (автоклав)


Наименование учреждения:

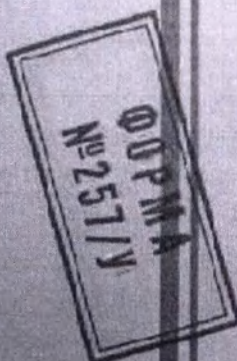

Начат: « » 20 г.
Окончен: « » 20 г.

Журнал регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее (форма, утвержденная Приказом Минздрава РФ №214 от 16.07.1997, Приложение Е)

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МАРКЕР

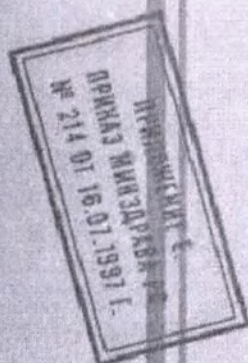

Наименование учреждения:

ЖУРНАЛ

регистрации режима стерилизации
исходных лекарственных веществ,
изготовленных лекарственных средств,
вспомогательных материалов, посуды и прочее.


Начат: « » 20 г.
Окончен: « » 20 г.

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МАРКЕР


ЖУРНАЛ

обеззараживания патогенных
биологических агентов.

Наименование учреждения: _____
отдела, отделения: _____
лаборатории: _____
временного формирования: _____

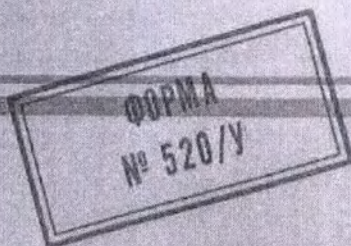

Начат: « » 20 г.
Окончен: « » 20 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ


по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024

- Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4;
- Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4;
- Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4;
- Индикатор химический интегрирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации, обеззараживания и воздушной стерилизации, класс 5;
- Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/180 мин., 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 134°C/18 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6;
- Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6, класс 5;
- Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6, класс 5;
- Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 5;
- Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-13» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 4;
- Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-5» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-6» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/90 мин., 126°C/60 мин., 132°C/45 мин., 134°C/27 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-7» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6;
- Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-8» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 132°C/90 мин., 134°C/60 мин., класс 6;
- Индикатор химический «ХимТест-О-9» для контроля параметров воздушного обеззараживания для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 4.

1. Общие сведения.

Данная инструкция распространяется на многопеременные индикаторы «ХимТест», 4 класс и имитирующие индикаторы «Маркер», класс 6 для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации (обеззараживания), производства ООО «НПО МАРКЕР» (далее – индикаторы).

Индикаторы предназначены для контроля параметров режимов стерилизации медицинских изделий, стерилизации лекарственных средств и питательных сред и парового обеззараживания медицинских отходов в паровых и воздушных стерилизаторах.

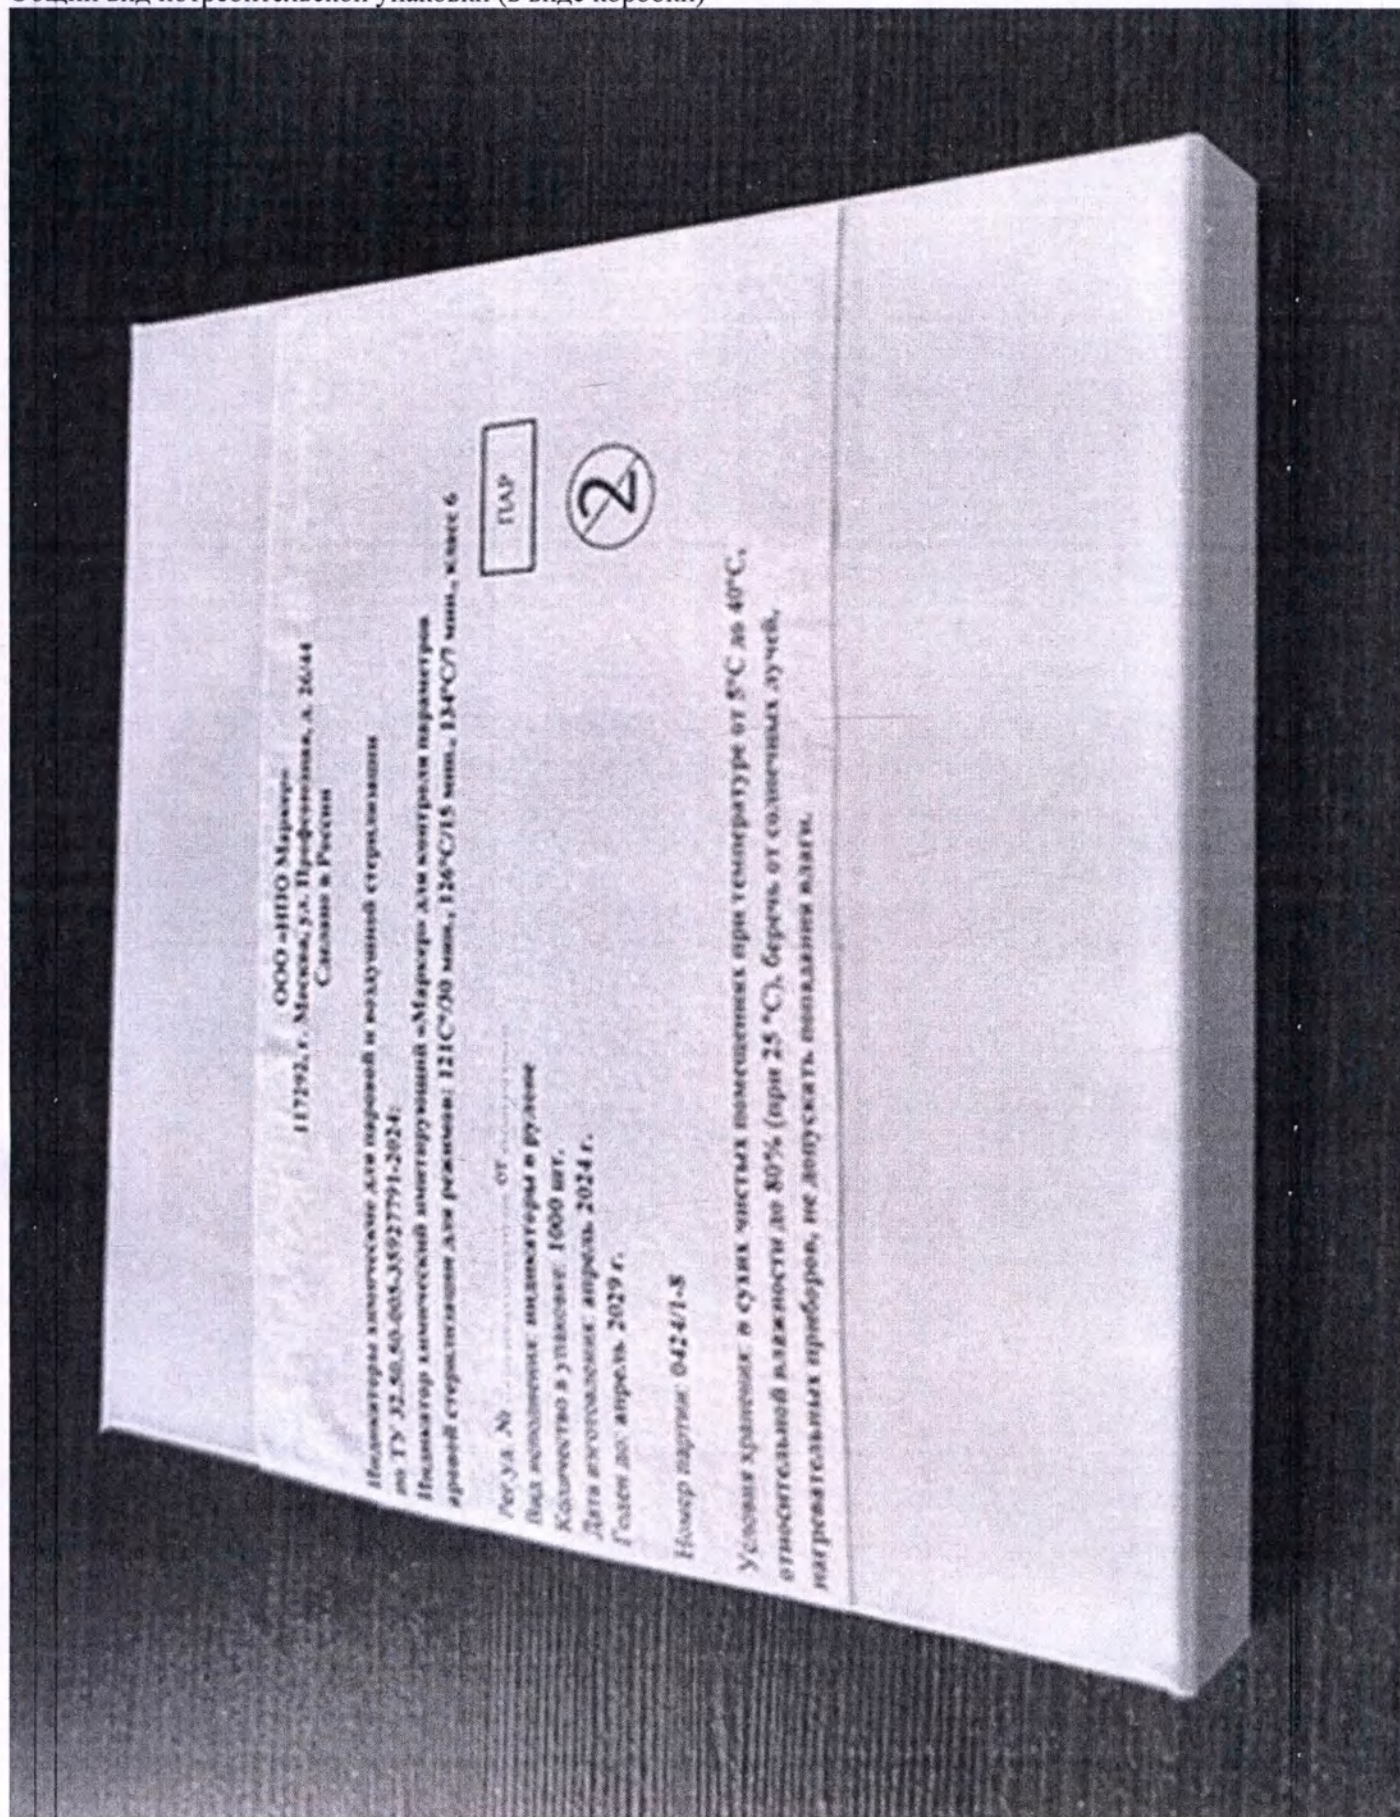

Общий вид потребительской упаковки (в виде конверта)

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический многоперемежный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной
стерилизации для режимов: 121°C/35мин.; 126°C/20мин.; 134°C/7мин.; 160°C/150мин.; 180°C/60мин.;
200°C/30мин., класс 4

Рег. уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-3

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО «НПО Маркус»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сездино и Россия

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024;
Индикатор химический «ХимТест-О-9» для контроля параметров воздушного обеззараживания для режимов: 160°C/150
мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 4

Рег.з. №
Вид исполнения: индикаторы в листках
Количество транспортной коробки: 40 000 шт.
Дата изготовления: апрель 2024 г.
Годов до: апрель 2029 г.
Номер партии: 0424/3-5

Условия транспортирования: производится любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки
грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °C до +50 °C, относительной влажности до 100%
(при 25°C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги

Генеральный директор
ООО «НПО Маркер»



И.П. Антонова

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

26 (двадцать шесть) листов



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«ВНИИО»

А.П. Антонова

10.10.2024 г

Макеты маркировки
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Макеты маркировки потребительской упаковки

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы


Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-1

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 4

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы


Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-2

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 121°C/35мин.; 126°C/20мин.; 134°C/7мин.; 160°C/150мин.; 180°C/60мин.; 200°C/30мин., класс 4

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе


Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-3

ПАР
ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический интегрирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации, обеззараживания и воздушной стерилизации, класс 5

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе


Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-4

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/180 мин., 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 134°C/18 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в рулоне**

Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **0424/1-5**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/17 мин., 126°C/10 мин., 134°C/4 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **отдельные индикаторы**


Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **0424/1-6**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в листе

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-7

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/15 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-8

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-9

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45мин.; 126°C/30мин.; 132°C/20мин., класс 6, класс 5

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годеи до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-10

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/20мин.; 126°C/10мин.; 134°C/5мин., класс 6, класс 5

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Гожен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-11

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический «Маркер» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов:
160°C/150мин.; 180°C/60мин.; 200°C/30мин., класс 6, класс 5

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Гожен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/1-12

ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-12» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/120 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 120°C/30 мин., класс 4

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **отдельные индикаторы**


Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **0424/2-1**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-5» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45мин., 120°C/30мин., 132°C/20мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в листе**


Количество в упаковке: **1000 шт.**

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**

Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **0424/3-1**

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-6» для контроля параметров парового
обеззараживания для режимов: 120°C/90 мин., 126°C/60 мин., 132°C/45 мин., 134°C/27 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/3-2

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-7» для контроля параметров парового
обеззараживания для режимов: 120°C/120 мин., 126°C/90 мин., 132°C/60 мин., 134°C/35 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2024 г.

Годен до: апрель 2029 г.

Номер партии: 0424/3-3

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

**Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:**

**Индикатор химический имитирующий «ХимТест-О-8» для контроля параметров парового
обеззараживания для режимов: 132°C/90 мин, 134°C/60 мин., класс 6**

Рег.уд. № от
Вид исполнения: индикаторы в листе
Количество в упаковке: 1000 шт.
Дата изготовления: апрель 2024 г.
Годен до: апрель 2029 г.
Номер партии: 0424/3-4

ПАР



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

**Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:**

**Индикатор химический «ХимТест-О-9» для контроля параметров воздушного обеззараживания для
режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 4**

Рег.уд. № от
Вид исполнения: индикаторы в рулоне
Количество в упаковке: 1000 шт.
Дата изготовления: апрель 2024 г.
Годен до: апрель 2029 г.
Номер партии: 0424/3-5

ВОЗД



Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ООО «НПО Маркер»
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-35927791-2024:

Индикатор химический «ХимТест-О-9» для контроля параметров воздушного обеззараживания для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6, класс 4

Рег.уд. № от

Вид исполнения: **индикаторы в листах**

Количество транспортной коробке: 40 000 шт.

Дата изготовления: **апрель 2024 г.**


Годеи до: **апрель 2029 г.**

Номер партии: **0424/3-5**


Условия транспортирования: производится любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта при температуре от -50 °C до +50 °C, относительной влажности до 100% (при 25°C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги



Генеральный директор
ООО «НПО Маркер»

 И.П. Антонова

Прочито, пронумеровано,
скреплено печатью

 11 (одиннадцать) листов