


**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

АО «Вектор-Бест»



 Хусаинов М.Д.

«12»  2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**  
**НАБОР РЕАГЕНТОВ**  
**ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО**  
**КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ**  
**ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G К ВИРУСУ КОРИ**  
**В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ**  
**(ВектоКорь-IgG)**  
**по ТУ 9398-354-23548172-2012**

**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия**  
**«Набор реагентов для иммуоферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)»**  
 (серия 1)




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №1  
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №2  
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №3  
(серия 1)

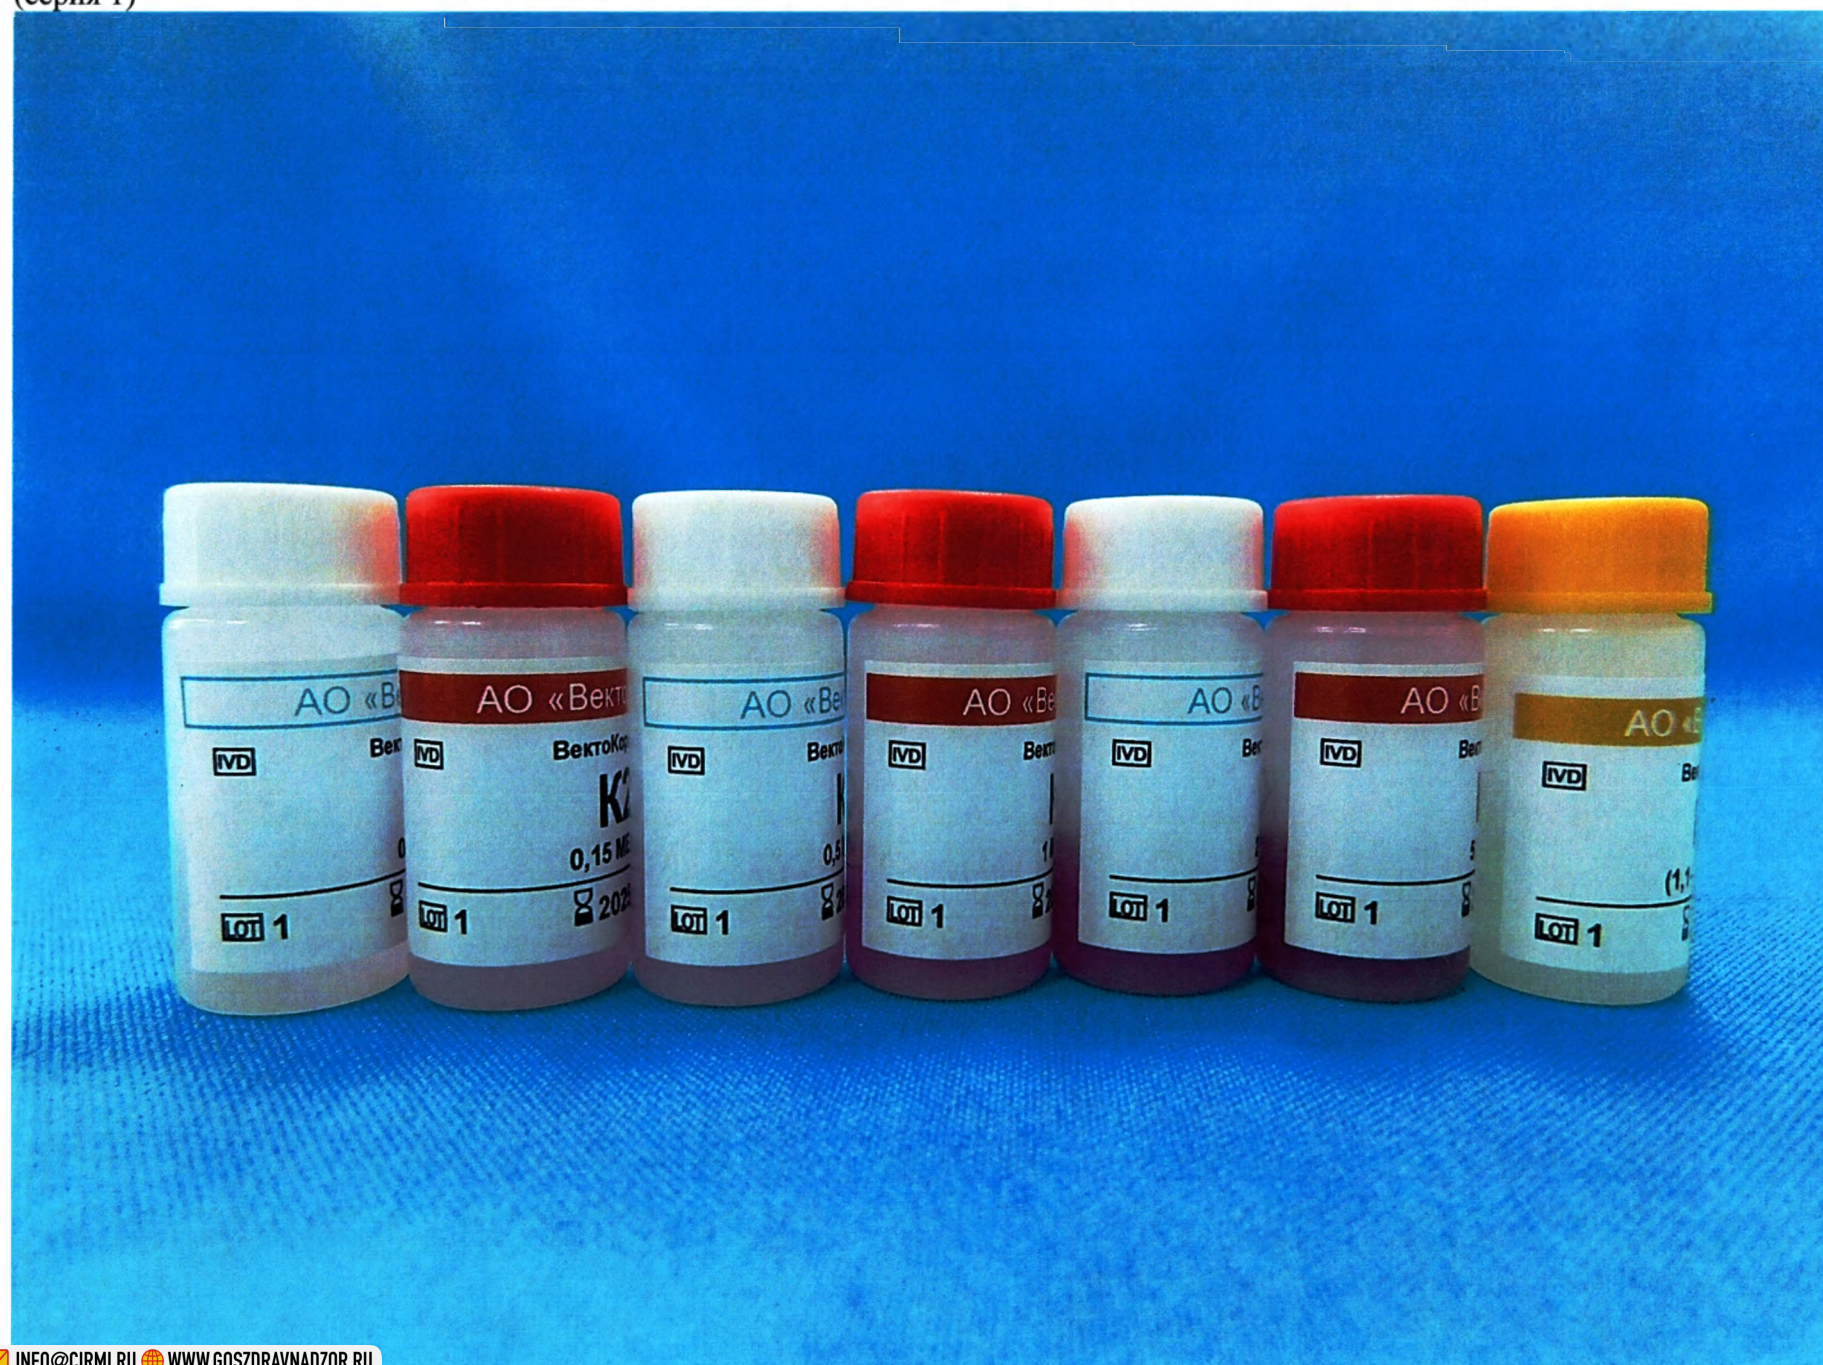

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №4  
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №5  
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия  
«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №6  
(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №7


(серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия




«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №8

(серия 1)

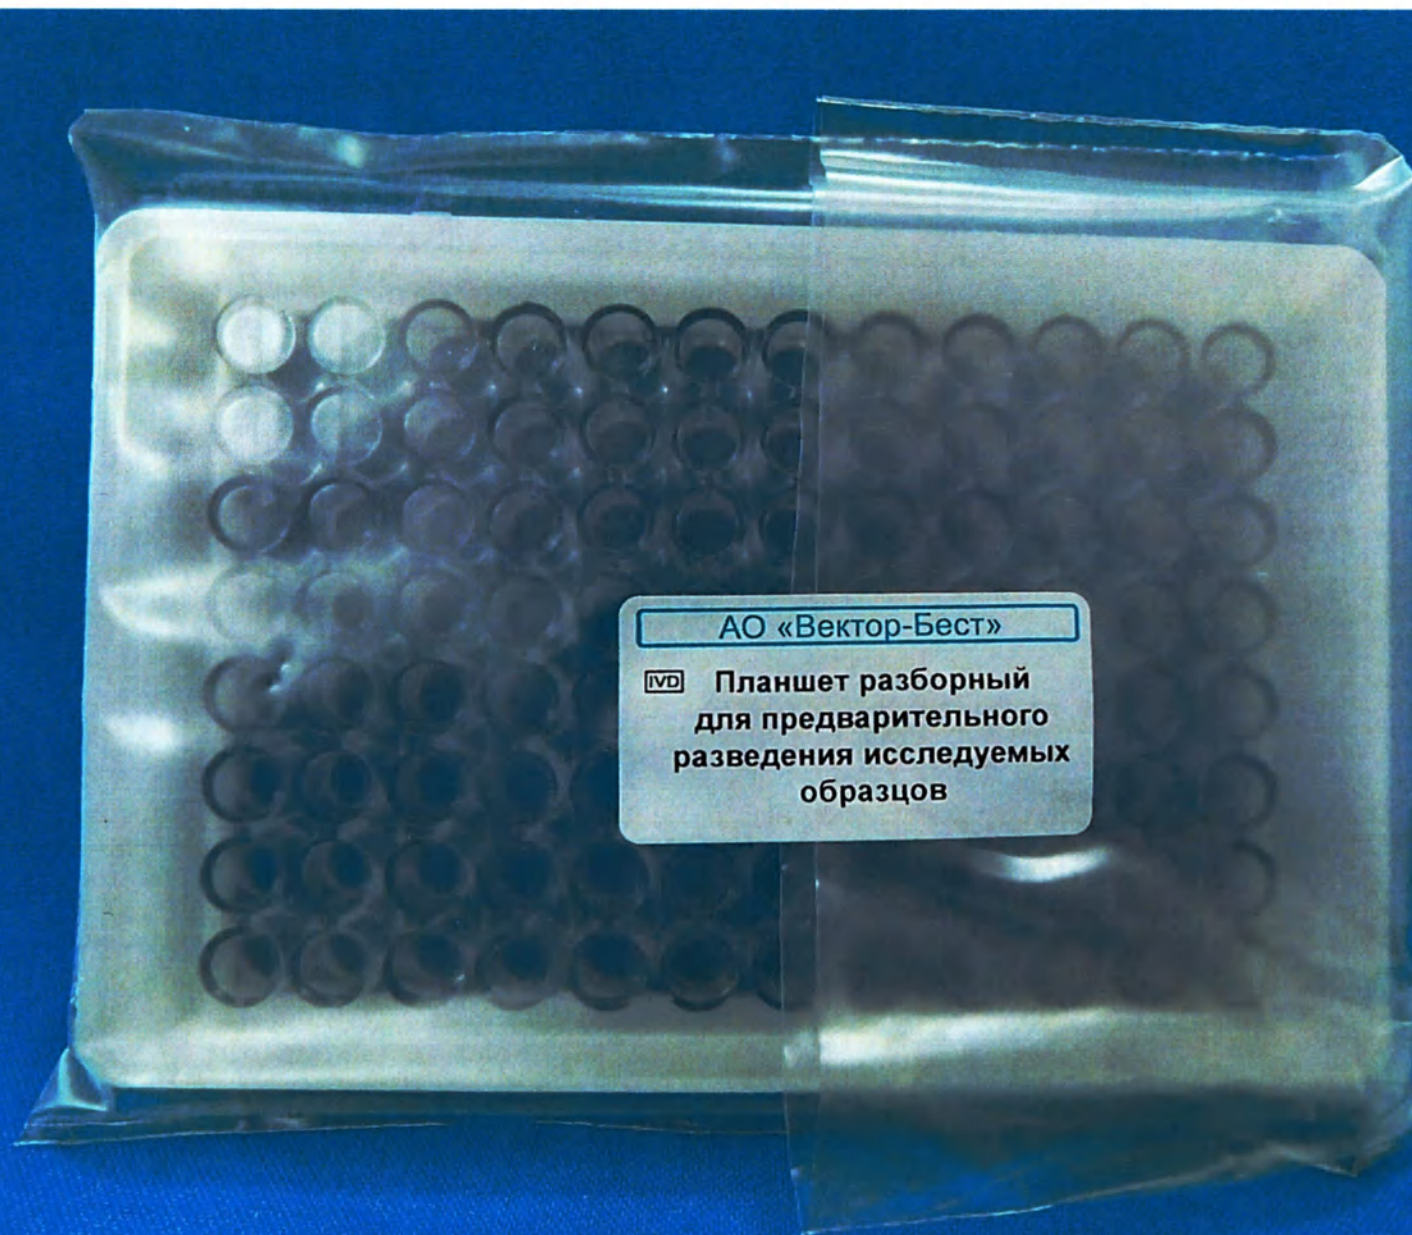

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №9  
(серия 1)

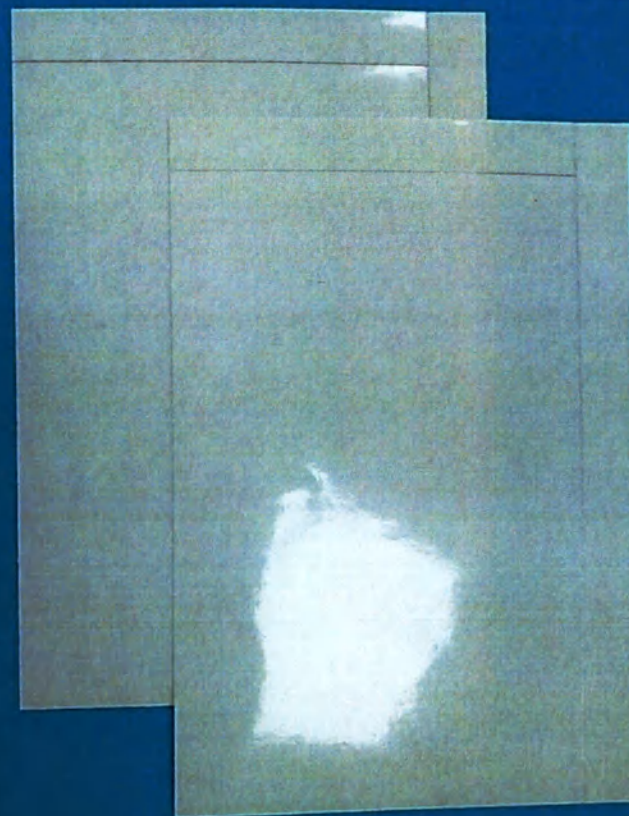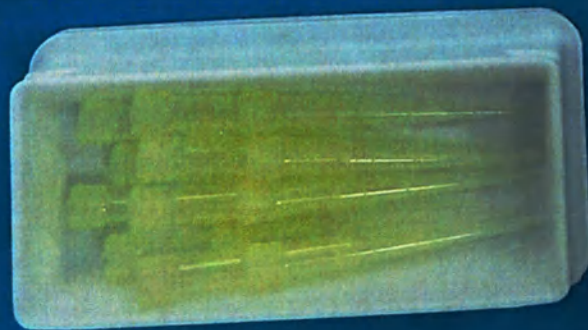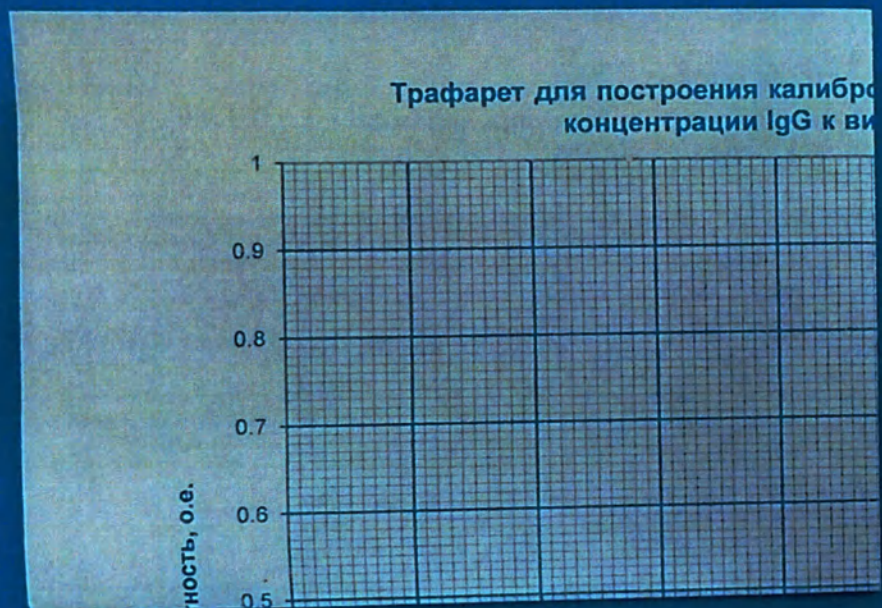


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №1

(серия 1)

ВЕКТОР

**БЕСТ**

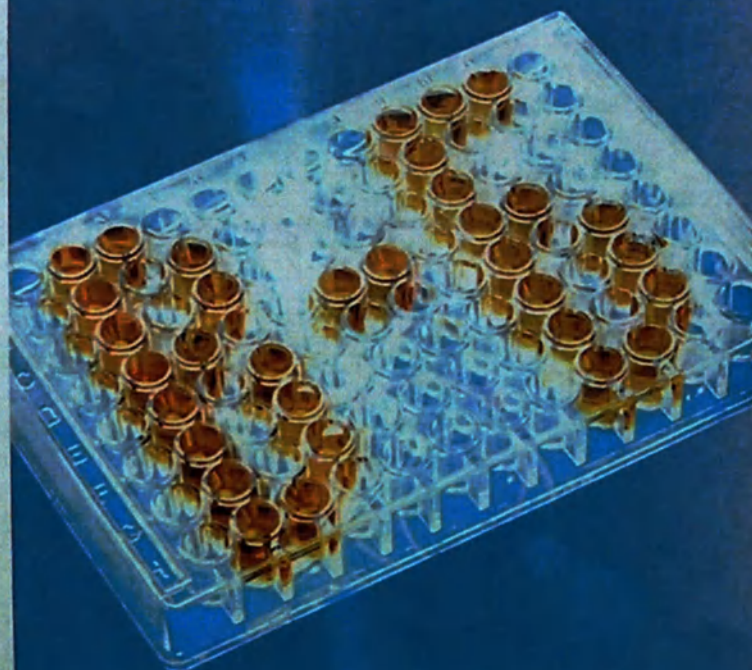

REF

**X-XXXX**

набор реагентов  
для иммуноферментного  
количественного и качественного  
определения иммуноглобулинов класса G  
к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови

**ВектоКорь-IgG**

LOT 1

СОСТАВ:


LOT

|                                                                              |        |            |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|
| 1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном вируса кори | 1 шт.  |            | 1 |
| 2. Калибровочные образцы (K1, K2, K3, K4, K5, K6)                            | 6 фл.  | по 1,5 мл  | 1 |
| 3. Контрольный образец (КО)                                                  | 1 фл.  | 1,5 мл     | 1 |
| 4. Конъюгат                                                                  | 1 фл.  | 13,0 мл    | 1 |
| 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС)                  | 1 фл.  | 10,0 мл    | 1 |
| 6. Раствор для разведения сывороток (PPC)                                    | 1 фл.  | 12,0 мл    | 1 |
| 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с таинном (ФСБ-Т-25)      | 2 фл.  | по 28,0 мл | 1 |
| 8. Раствор тетраметилбензидаина плюс (Раствор ТМБ плюс)                      | 1 фл.  | 13,0 мл    | 1 |
| 9. Стоп-реагент                                                              | 1 фл.  | 12,0 мл    | 1 |
| 10. Пленка для заклеивания планшета                                          | 2 шт.  |            |   |
| 11. Ванночка для реагентов                                                   | 2 шт.  |            |   |
| 12. Наконечники для дозаторов на 5–200 мкл                                   | 16 шт. |            |   |
| 13. Трафарет для построения калибровочного графика                           | 1 шт.  |            |   |
| 14. Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов   | 1 шт.  |            |   |

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №2


(серия 1)

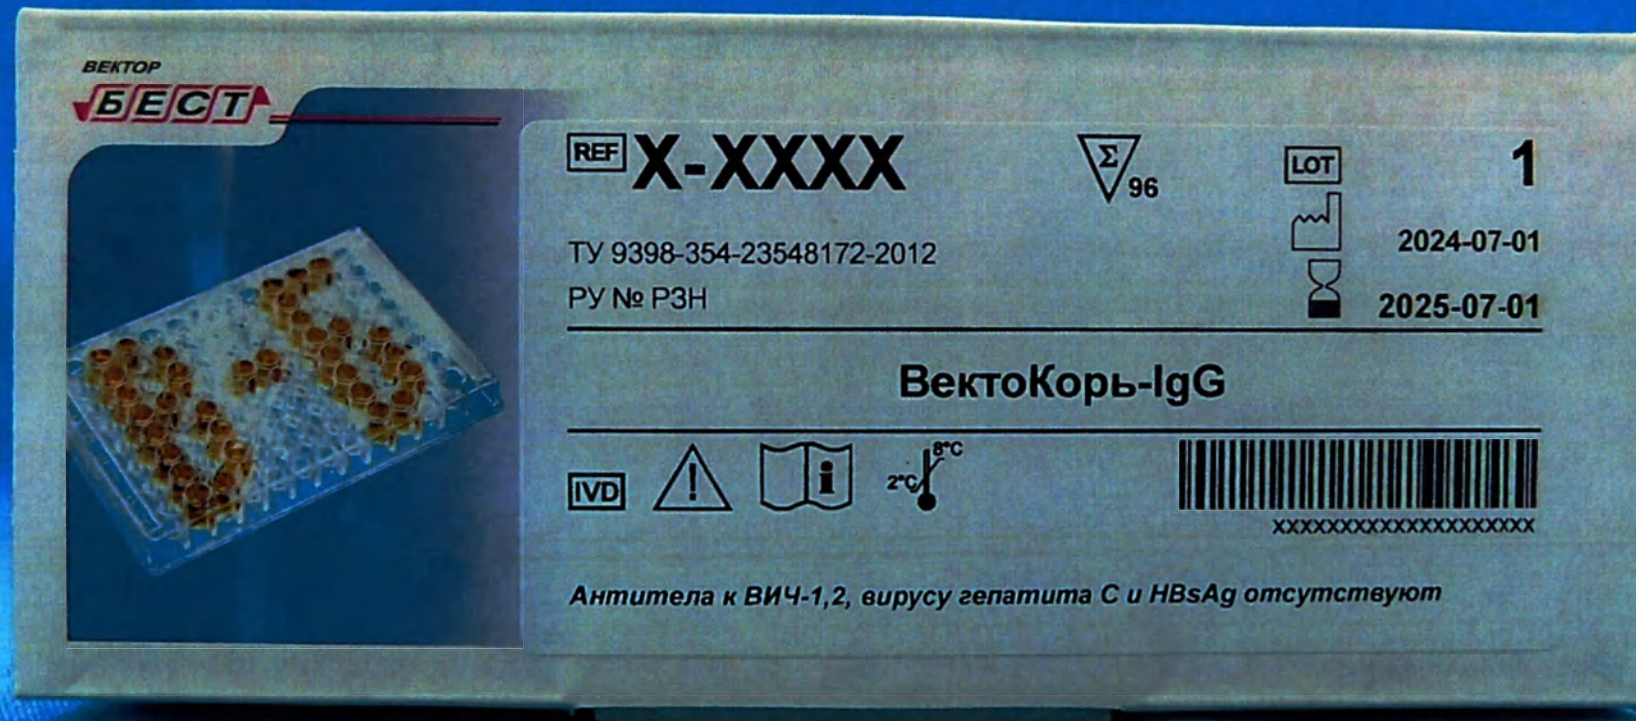

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке (плазме) крови (ВектоКорь-IgG)» №3

(серия 1)

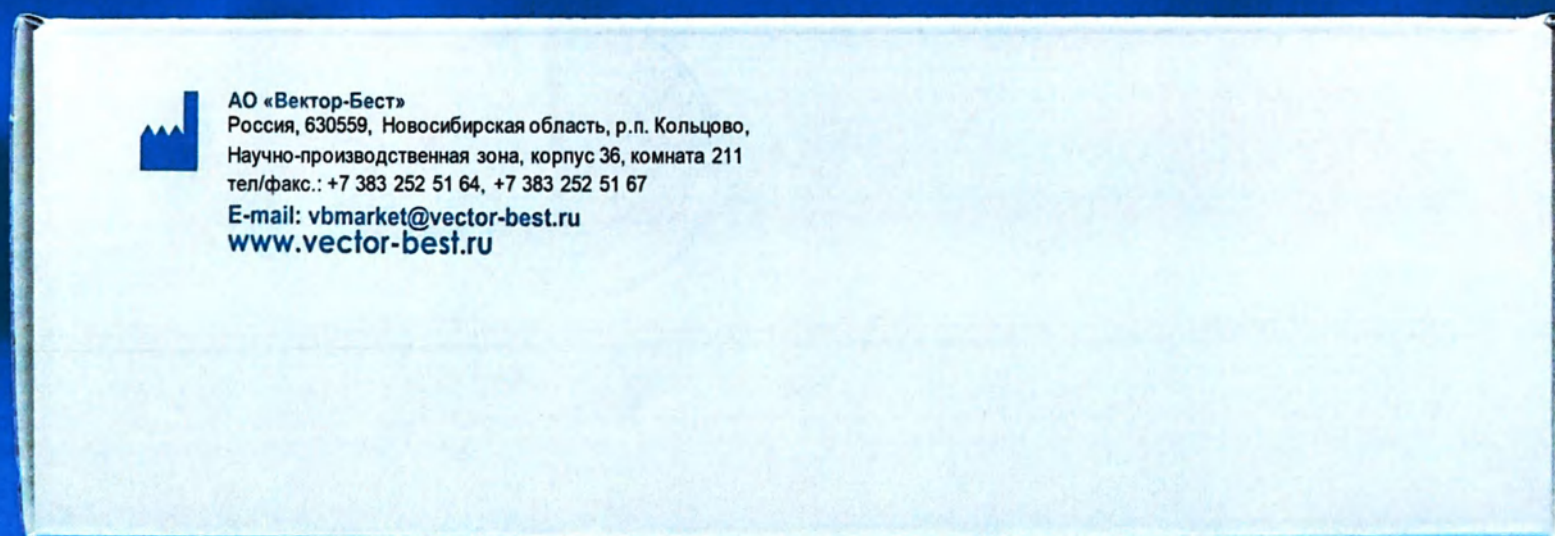



Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 14 листов.

Директор по технологии и качеству  
АО «Вектор-Бест»

«02» 09 сентября 20 24 г.

Масяго А.В.