



**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов
класса G к вирусу простого герпеса I типа» «ИФА – ВПГ - 1-IgG»**

Комплект №1 Серия 01 от 2020.01



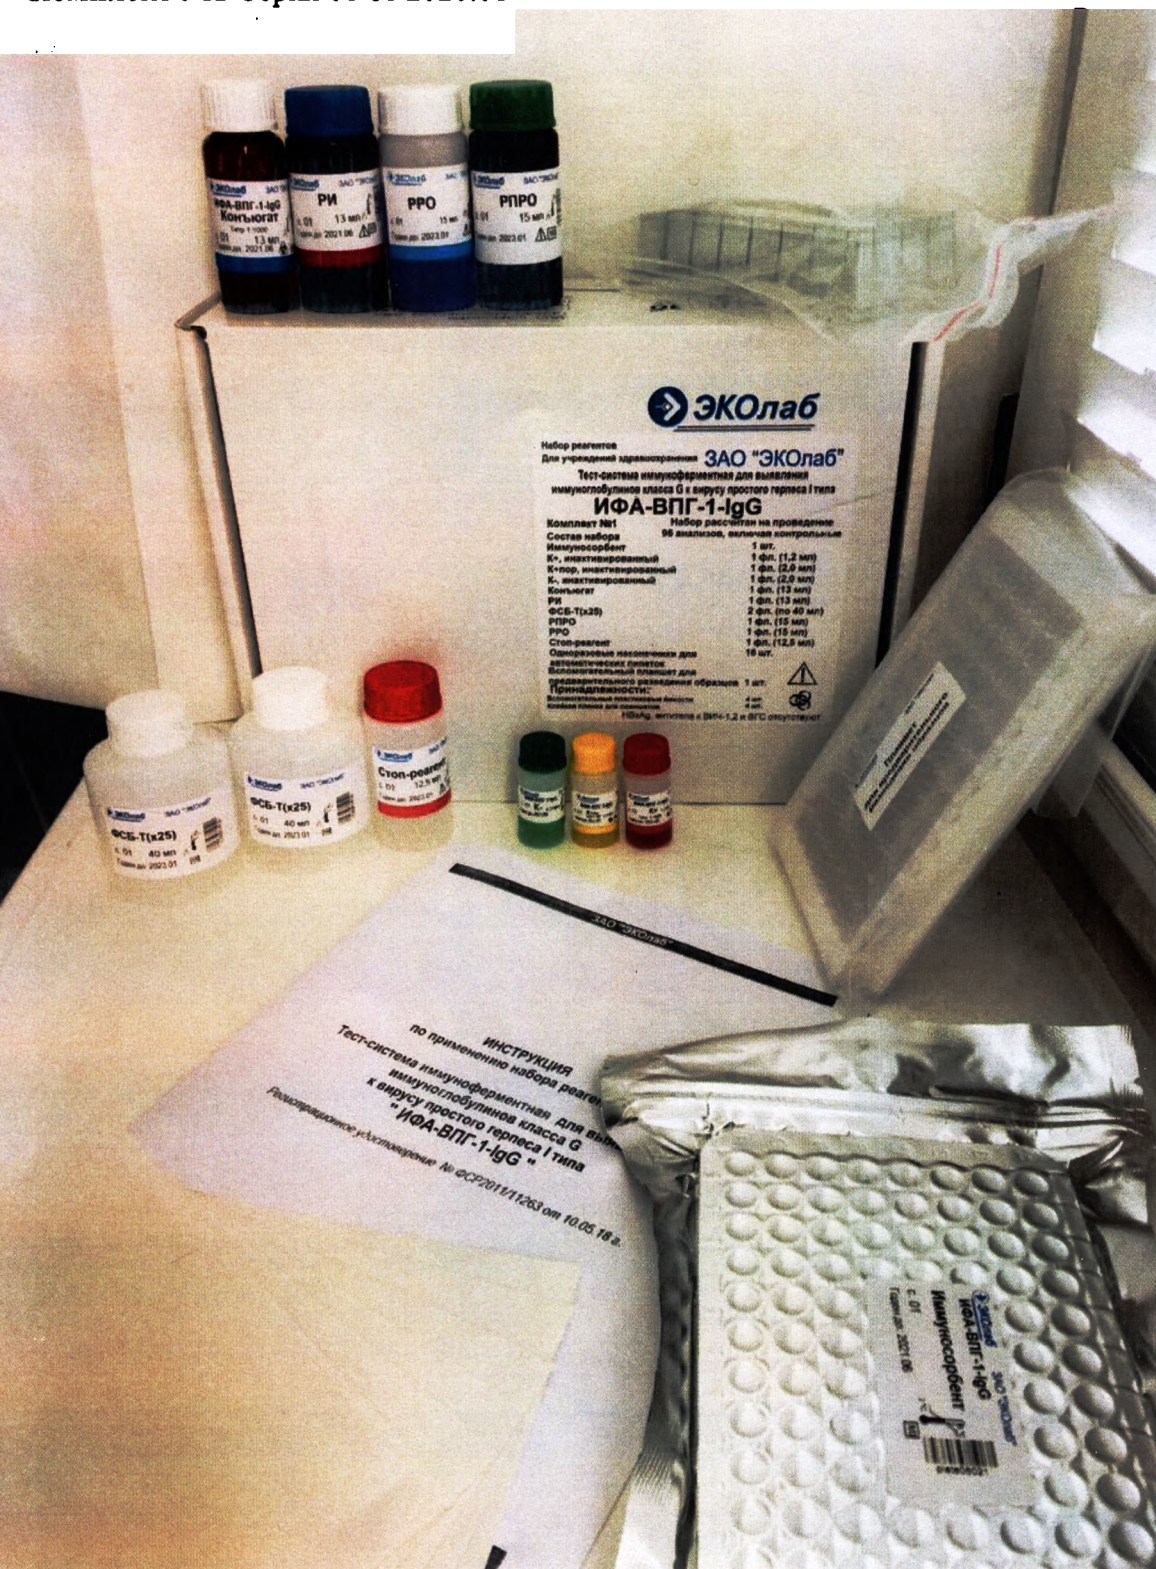

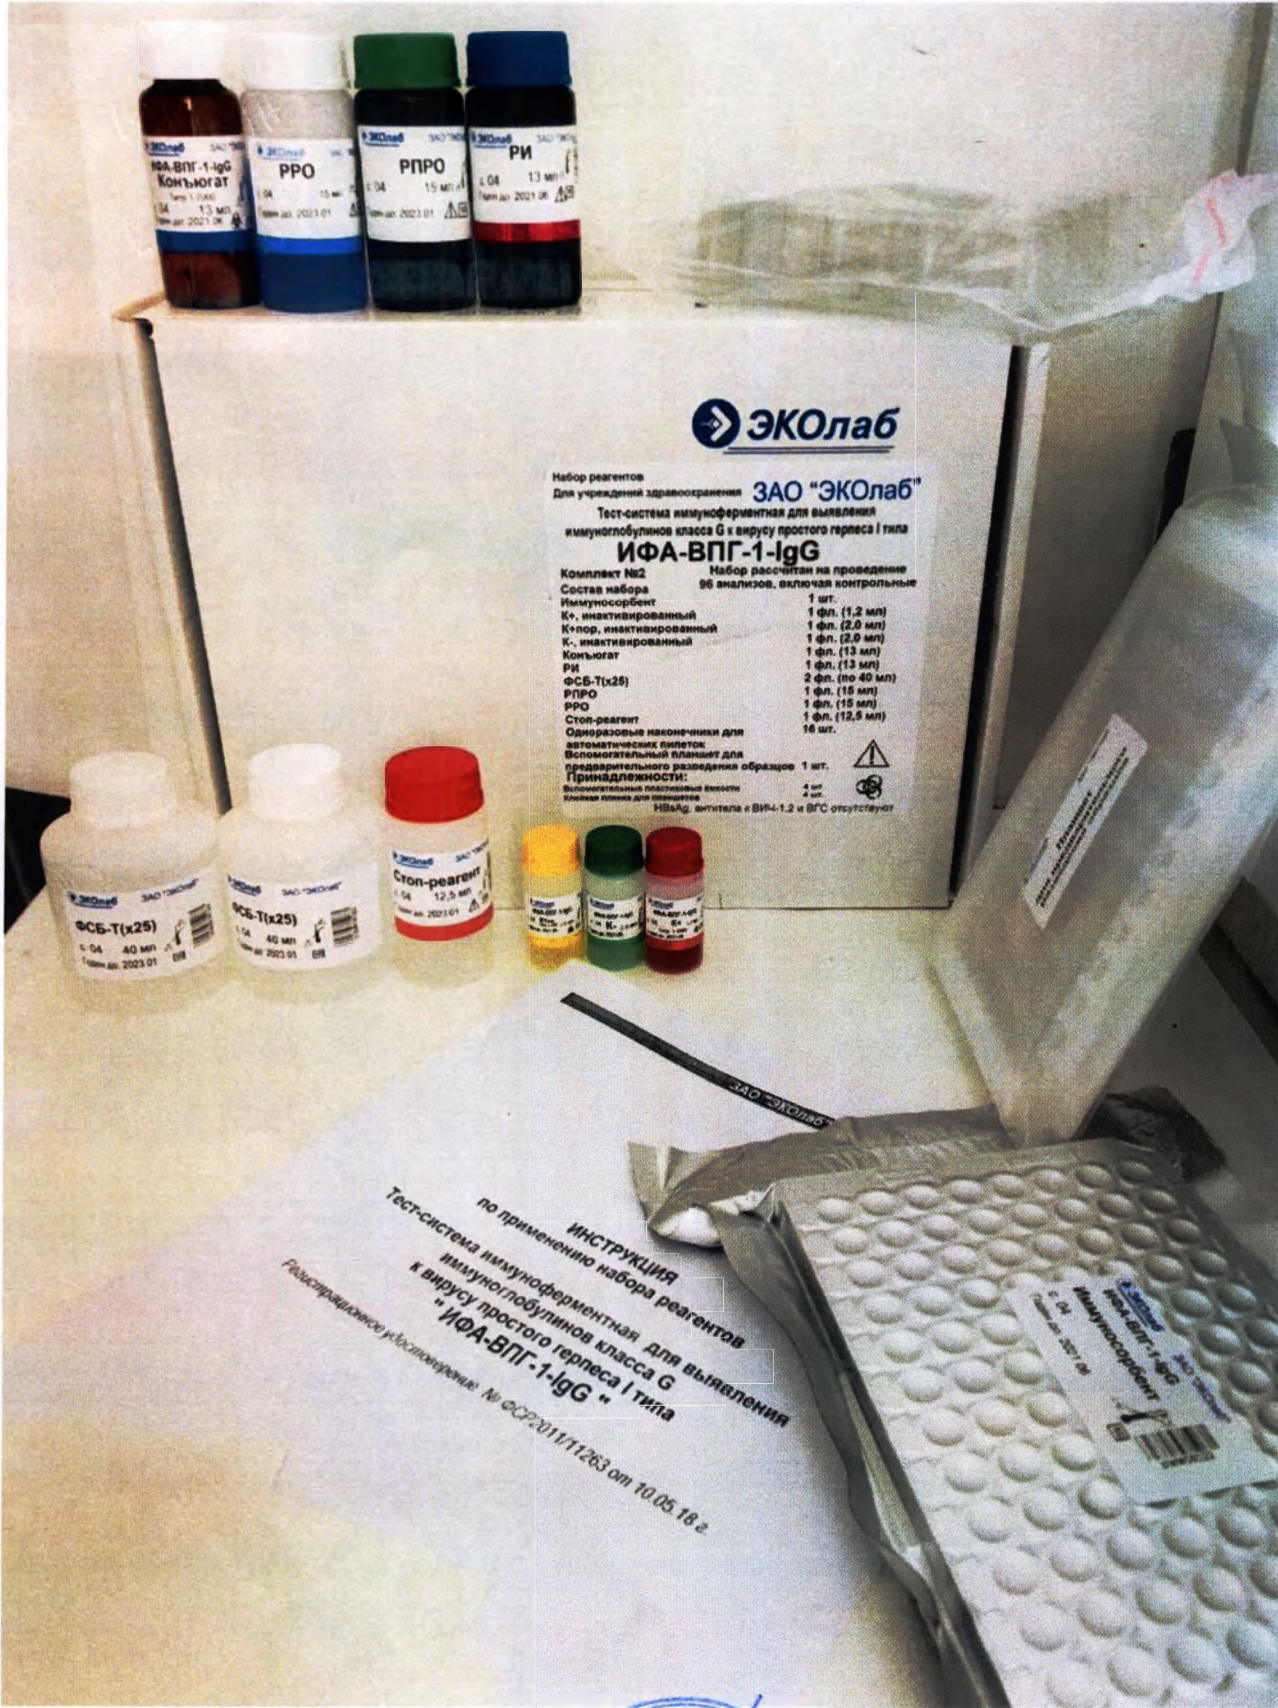

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4/2577-лист 2

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Борисов В.Ю.

"09" 08 2020 г.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 типа

ИФА-ВПГ-1-IgG

Комплект №1

Состав набора

Иммунсорбент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 год.



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1-IgG

ТУ 9398-047-70423725-2020

ПУ №ФСР 2011/11263 от 10.05.2018








Каталожный № 08.02.1

Серия 01

Контрольный № 23

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06

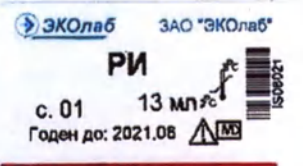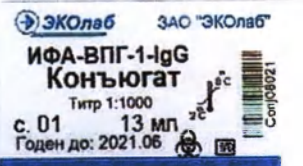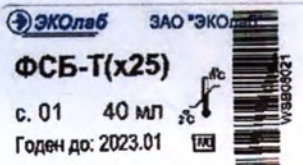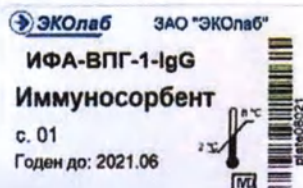

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса I типа

ИФА-ВПГ-1-IgG

Комплект №2

Состав набора

Иммунорсorbент

K+, инактивированный

K+пор, инактивированный

K-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РПРО

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для

автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов 1 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.

Клейкая пленка для планшетов 4 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (2,0 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1-IgG

Иммунорсorbент

с. 02

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 02

Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1-IgG

Конъюгат

с. 02

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

РРО

с. 02

Годен до: 2023.01




ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 02

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 02

Годен до: 2023.01



ЗАО "ЭКОлаб"

РПРО

с. 02

Годен до: 2021.06



ЗАО "ЭКОлаб"

Планшет
для предварительного
разведения образцов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 год.



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1-IgG

ТУ 9398-047-70423725-2020


ПУ №ФСР 2011/11263 от 10.05.2018

Каталожный № 08.02.2

Серия 02 Контрольный № 24

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.06



08.02.2

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1-IgG

с. 02 K+ 1,2 мл

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Годен до: 2021.06

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.



Пронумеровано, проинформировано
и скреплено печатью
Лист 219601
Ген. Директор ЗАО "ЭКОЛаб"
Борисов В.Ю.
"09" 2020 г.

