

УТВЕРЖДАЮ

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treponema pallidum*

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

Комплект №1/1

Состав набора

Иммунсорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат
PP
[ФСБ-Т(x25)]
РИ
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

2 планшета
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
2 фл. (по 14 мл)
1 фл. (2,0 мл)
2 фл. (по 40 мл)
2 фл. (по 14 мл)
1 фл. (25 мл)

16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г

Для профессионального применения

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм. №1

РУ №

Комплект № 1/1

LOT 01

2022.03.30









REF 03.25.1/1

2024.03.30

Контрольный № 939



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

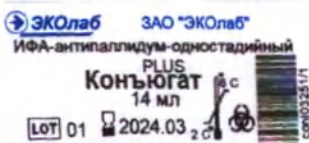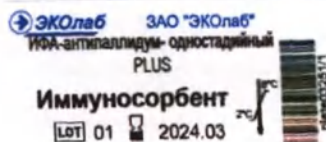

для учреждений здравоохранения
набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treponema pallidum*

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

Комплект №1/2

Состав набора

Иммуносорбент
K+, инактивированный
K-, инактивированный
Конъюгат
PP
ФСБ-Т(x25)
ЦБР
Хромоген (ТМБ)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток


2 планшета
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
2 фл. (по 14 мл)
1 фл. (2,0 мл)
2 фл. (по 40 мл)
2 фл. (по 14 мл)
1 фл. (2,0 мл)
1 фл. (25 мл)

16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г



Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм.№1

РУ №

Комплект № 1/2

LOT 02



2022.03.30

REF 03.25.1/2












2024.03.30

Контрольный № 939



03.25.1/2

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

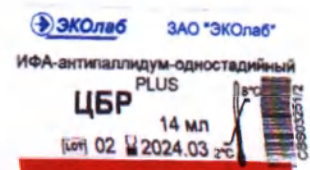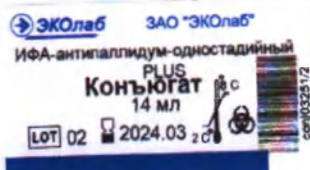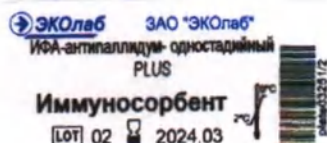

УТВЕРЖДАЮ

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treropema pallidum*

ИФА-антипаллидум-однотайный PLUS

Комплект №2/1

Состав набора



Иммуносорбент
K+, инактивированный
K-, инактивированный
Конъюгат
PP
[ФСБ-Т(x25)]
РИ
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

1 планшет
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (14 мл)
1 фл. (1,0 мл)
1 фл. (40 мл)
1 фл. (14 мл)
1 фл. (12,5 мл)
16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2022 г



Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антипаллидум-однотайный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм.№1

РУ №

Комплект № 2/1

LOT 03

2022.03.30









REF 03.25.2/1

2024.03.30

Контрольный № 941



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

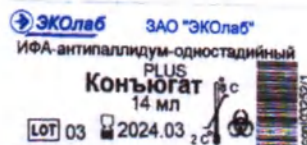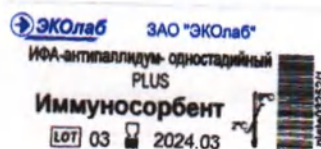

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г



Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treponema pallidum*

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS


Комплект №2/2

Состав набора

Иммунсорбент	1 планшет
К+, инактивированный	1 фл. (1,0 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (1,0 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
PP	1 фл. (1,0 мл)
[ФСБ-Т(x25)]	1 фл. (40 мл)
ЦБР	1 фл. (14 мл)
Хромоген (ТМБ)	1 фл. (1,0 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм.№1

РУ №

Комплект № 2/2

LOT 04

2022.03.30









REF 03.25.2/2

2024.03.30

Контрольный № 942



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

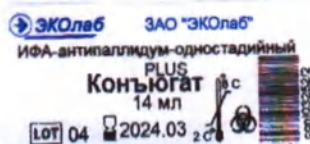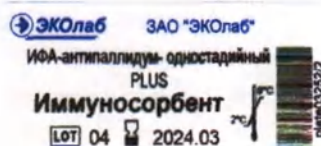

для учреждений здравоохранения
набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treponema pallidum*

ИФА-антипаллидум-однотадийный PLUS

Комплект №3/1


Состав набора

Иммуносорбент	5 планшетов
K+, инактивированный	2 фл. (по 2,5 мл)
K-, инактивированный	2 фл. (по 2,5 мл)
Конъюгат	5 фл. (по 14 мл)
PP	1 фл. (5,0 мл)
[ФСБ-Т(x25)]	3 фл. (по 100 мл)
PI	5 фл. (по 14 мл)
Стоп-реагент	3 фл. (по 25 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	32 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

8 шт.
8 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антипаллидум-однотадийный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм.№1

РУ №

Комплект № 3/1

LOT 05

2022.03.30








REF 03.25.3/1

2024.03.30

Контрольный № 943



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

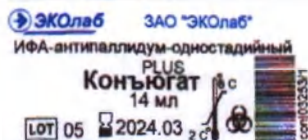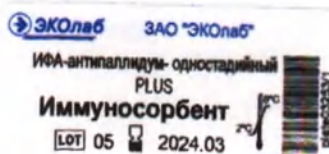

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител всех классов к *Treponema pallidum*

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

Комплект №3/2

Состав набора

Иммуносорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат
PP
[ФСБ-Т(x25)]
ЦБР
Хромоген (ТМБ)
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток


5 планшетов
2 фл. (по 2,5 мл)
2 фл. (по 2,5 мл)
5 фл. (по 14 мл)
1 фл. (5,0 мл)
3 фл. (по 100 мл)
5 фл. (по 14 мл)
1 фл. (5,0 мл)
3 фл. (по 25 мл)

32 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

8 шт.
8 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антипаллидум-одностадийный PLUS

ТУ 21.20.23-106-70423725-2021 с изм.№1

РУ №

Комплект № 3/2

LOT 06

2022.03.30










REF 03.25.3/2

2024.03.30

Контрольный № 944



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

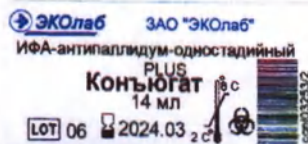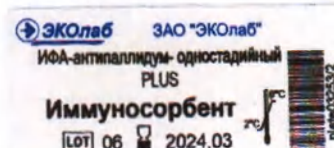



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью





6 лист 06
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
13 05 2022 г.

Комплект №1/1, Серия 01, дата изготовления 2022.03, годен до 2024.03




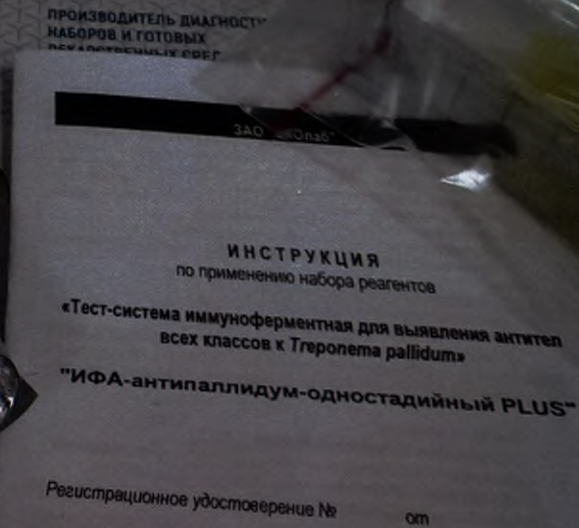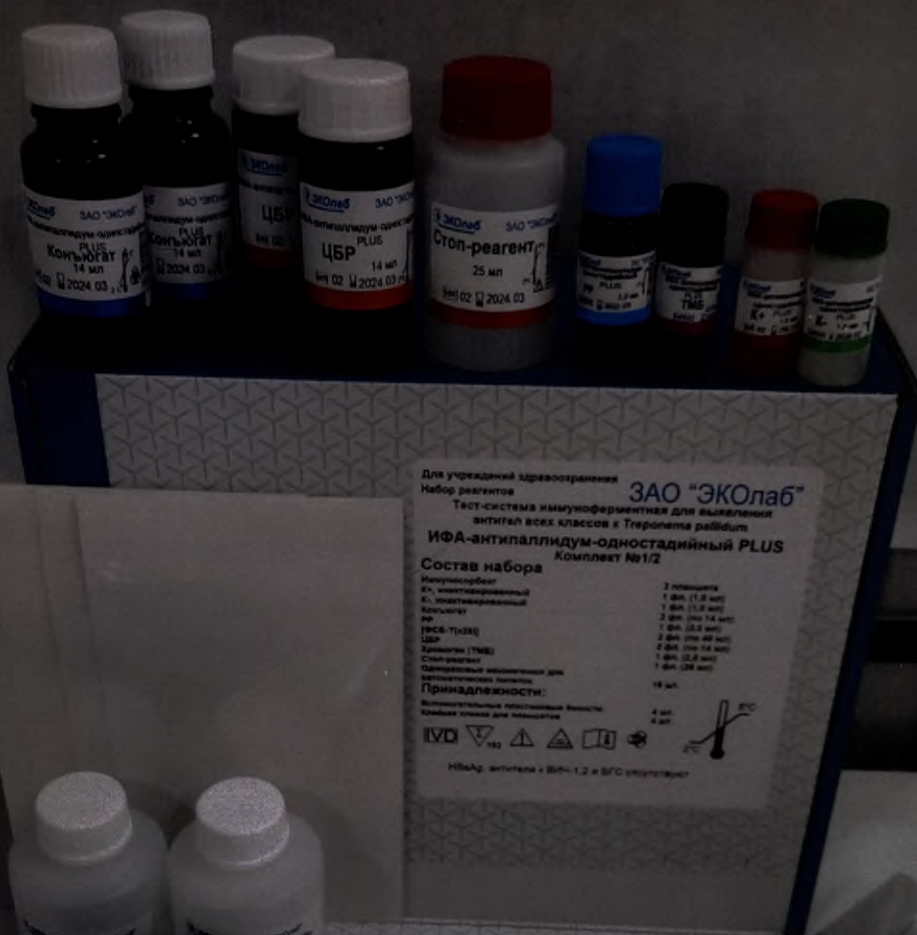

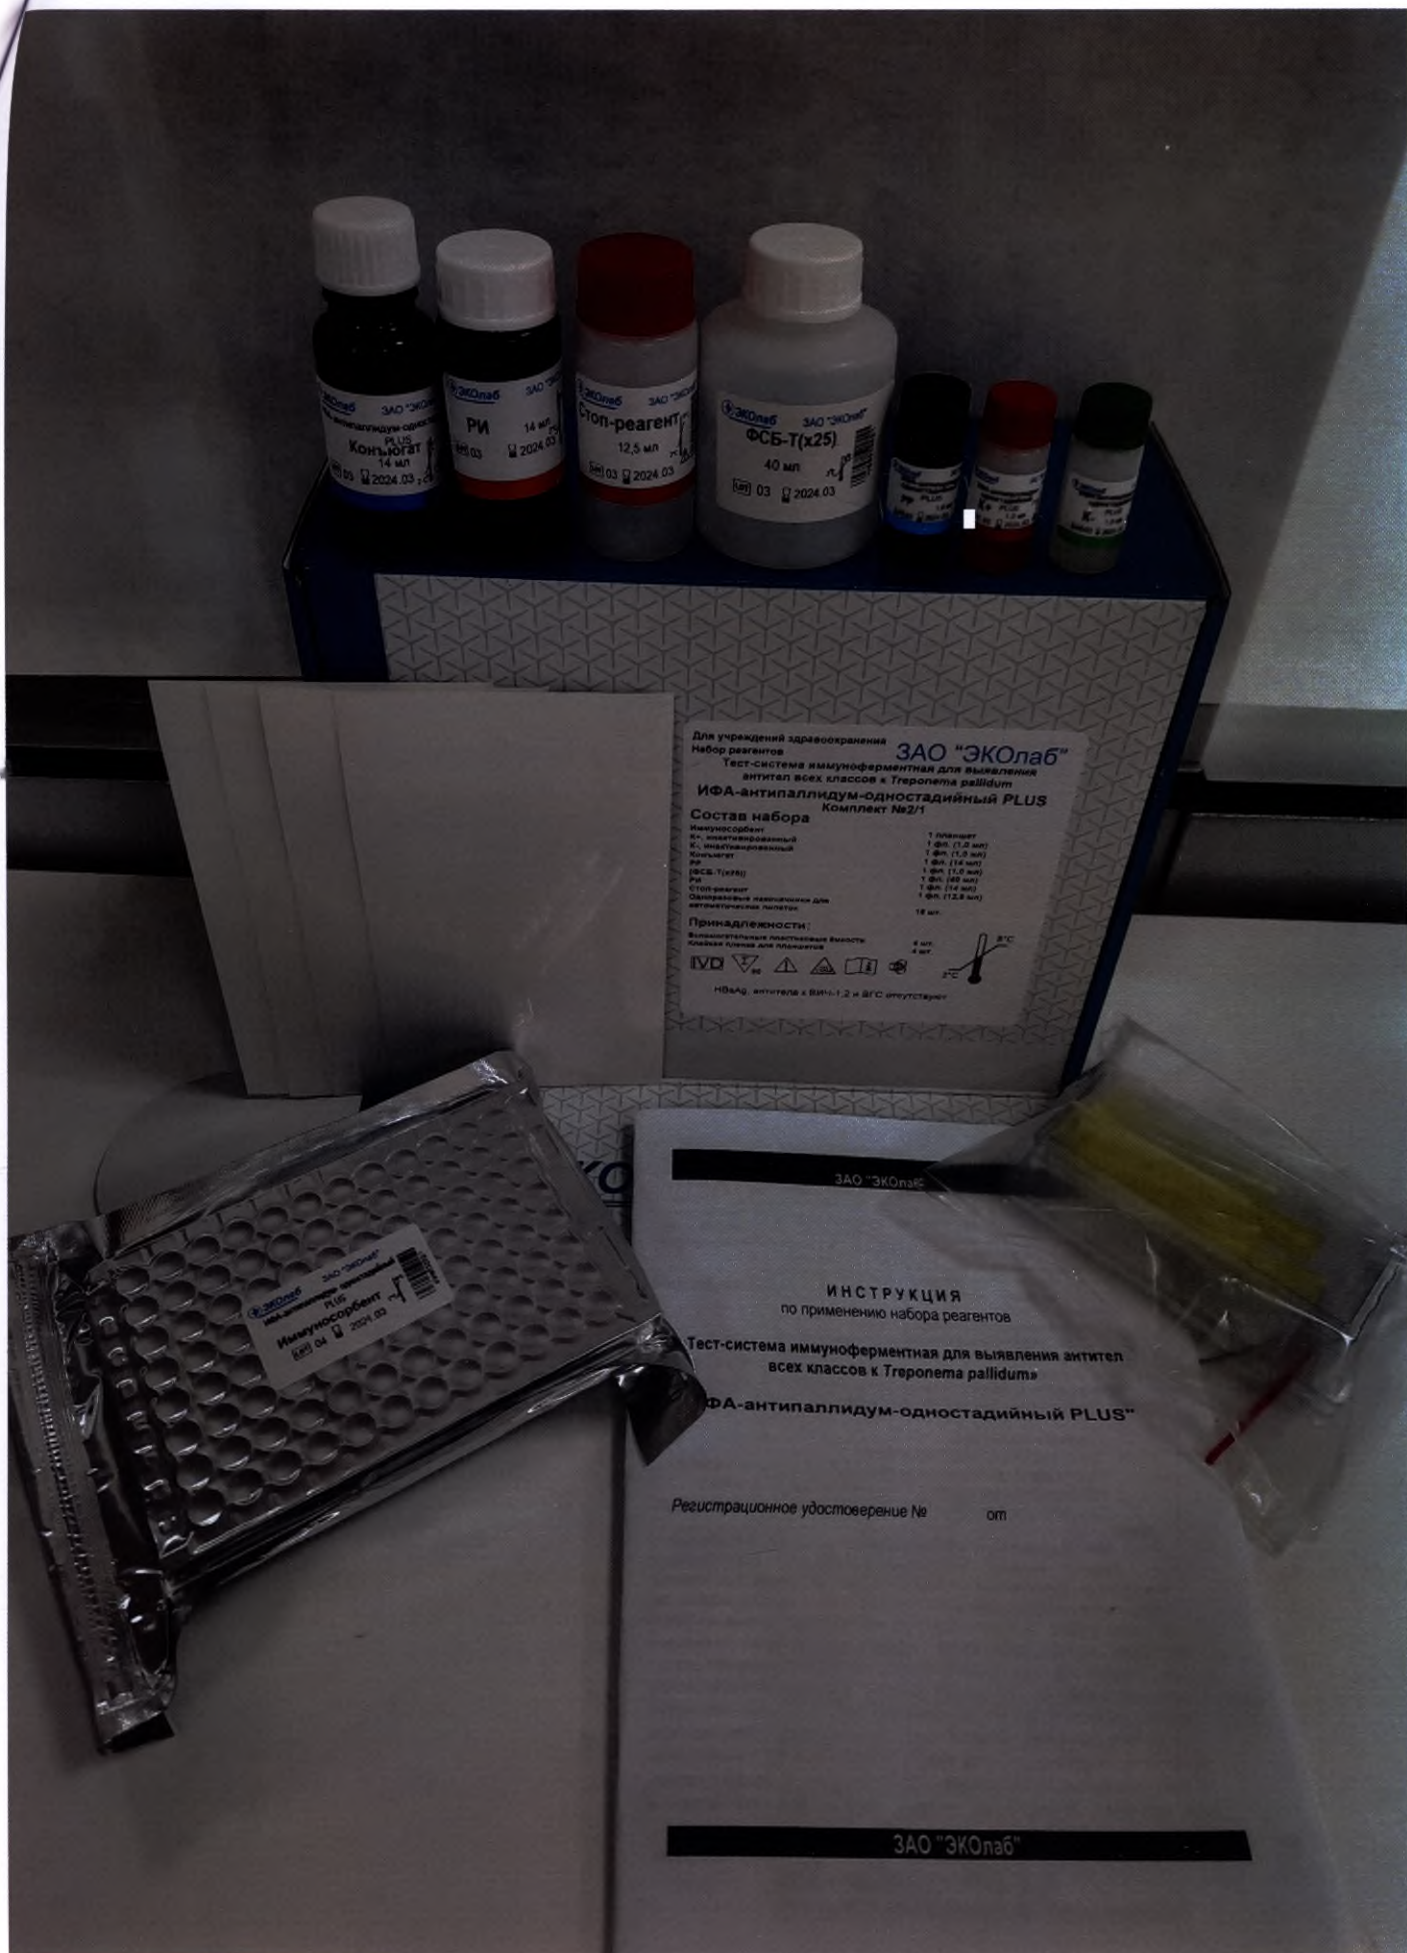

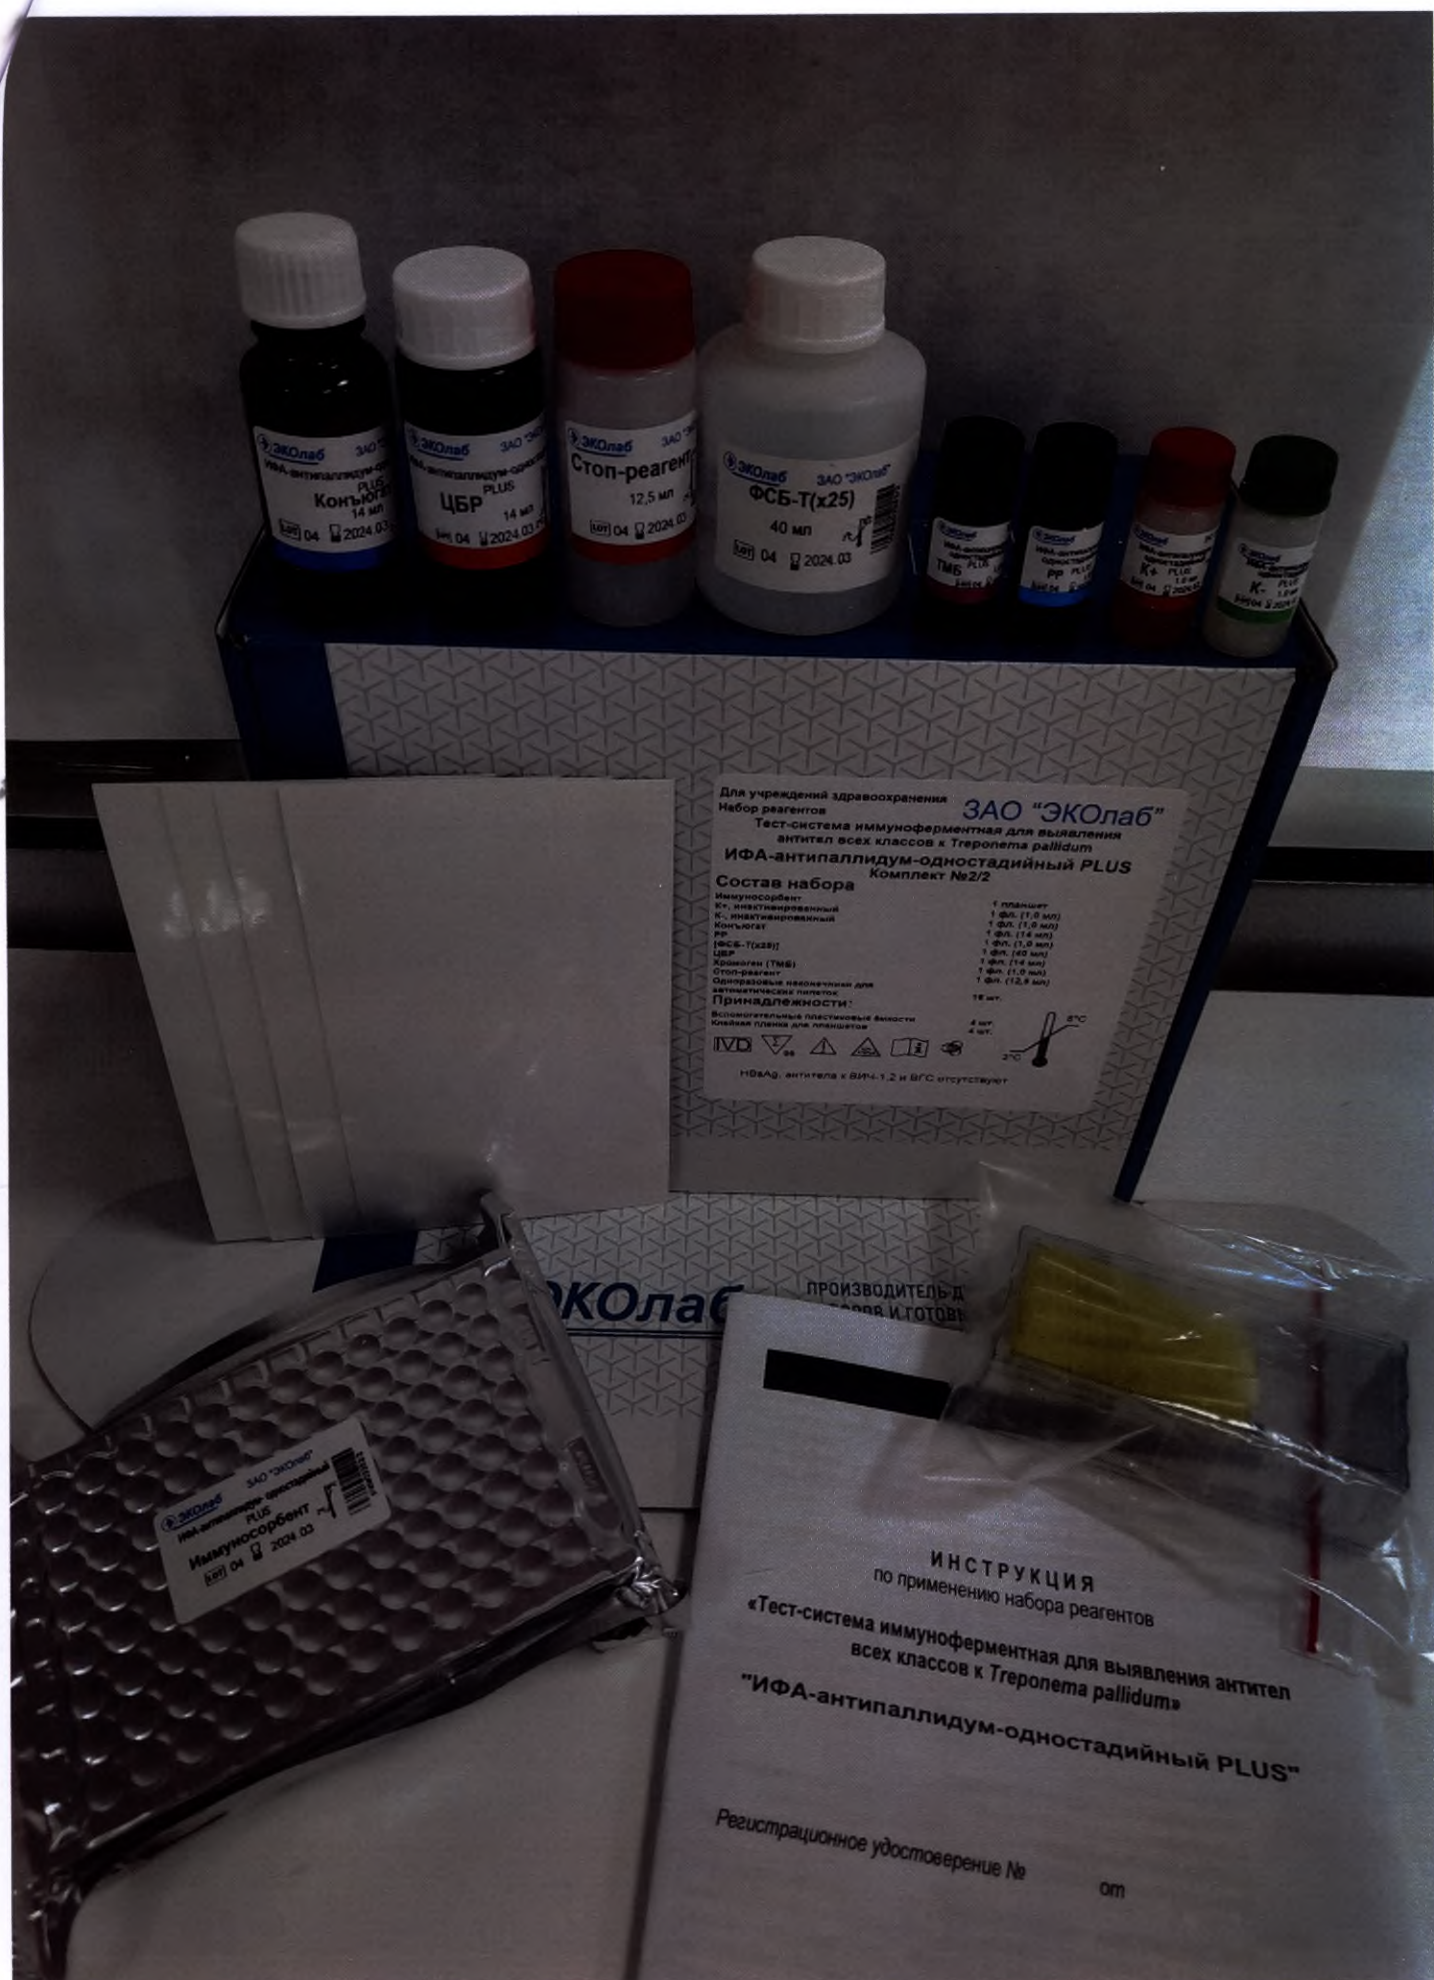

плект № 3/1, Серия 05, дата изготовления 2022.03, годен до 2024.03;

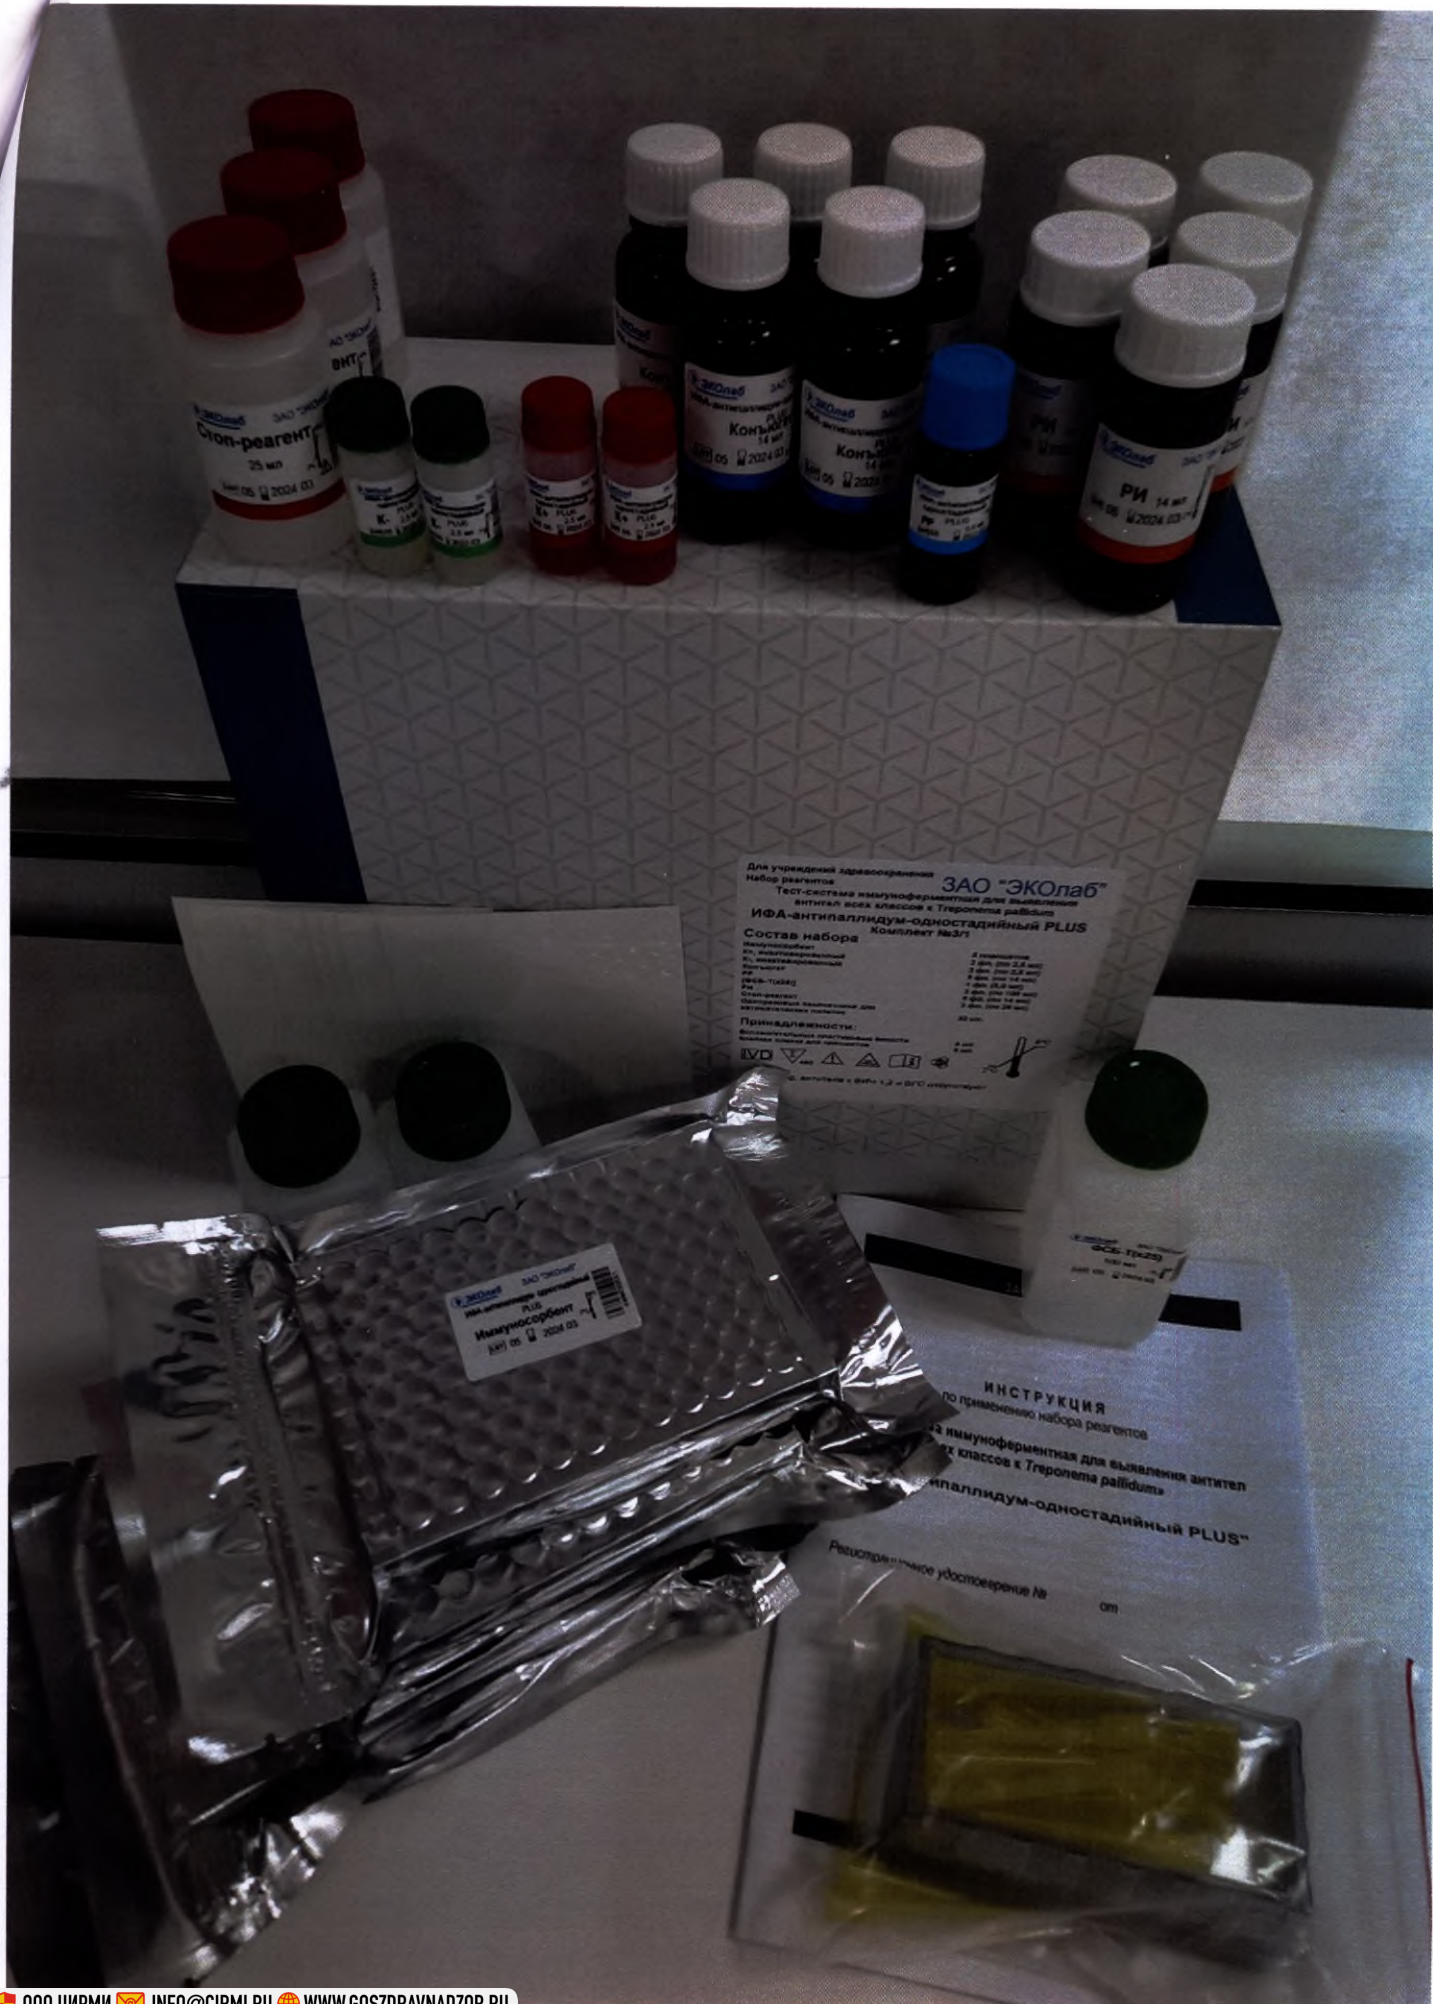



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



6 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"12" 05 2022 г.

[illegible]

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU