

**Фотографические изображения общего вида**

**Набора реагентов**

**«КовидЭк Директ» для качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени.**

**Комплект №1**

**Серия 03 от 2021.07.02**

**Общий вид набора реагентов «КовидЭк Директ»**

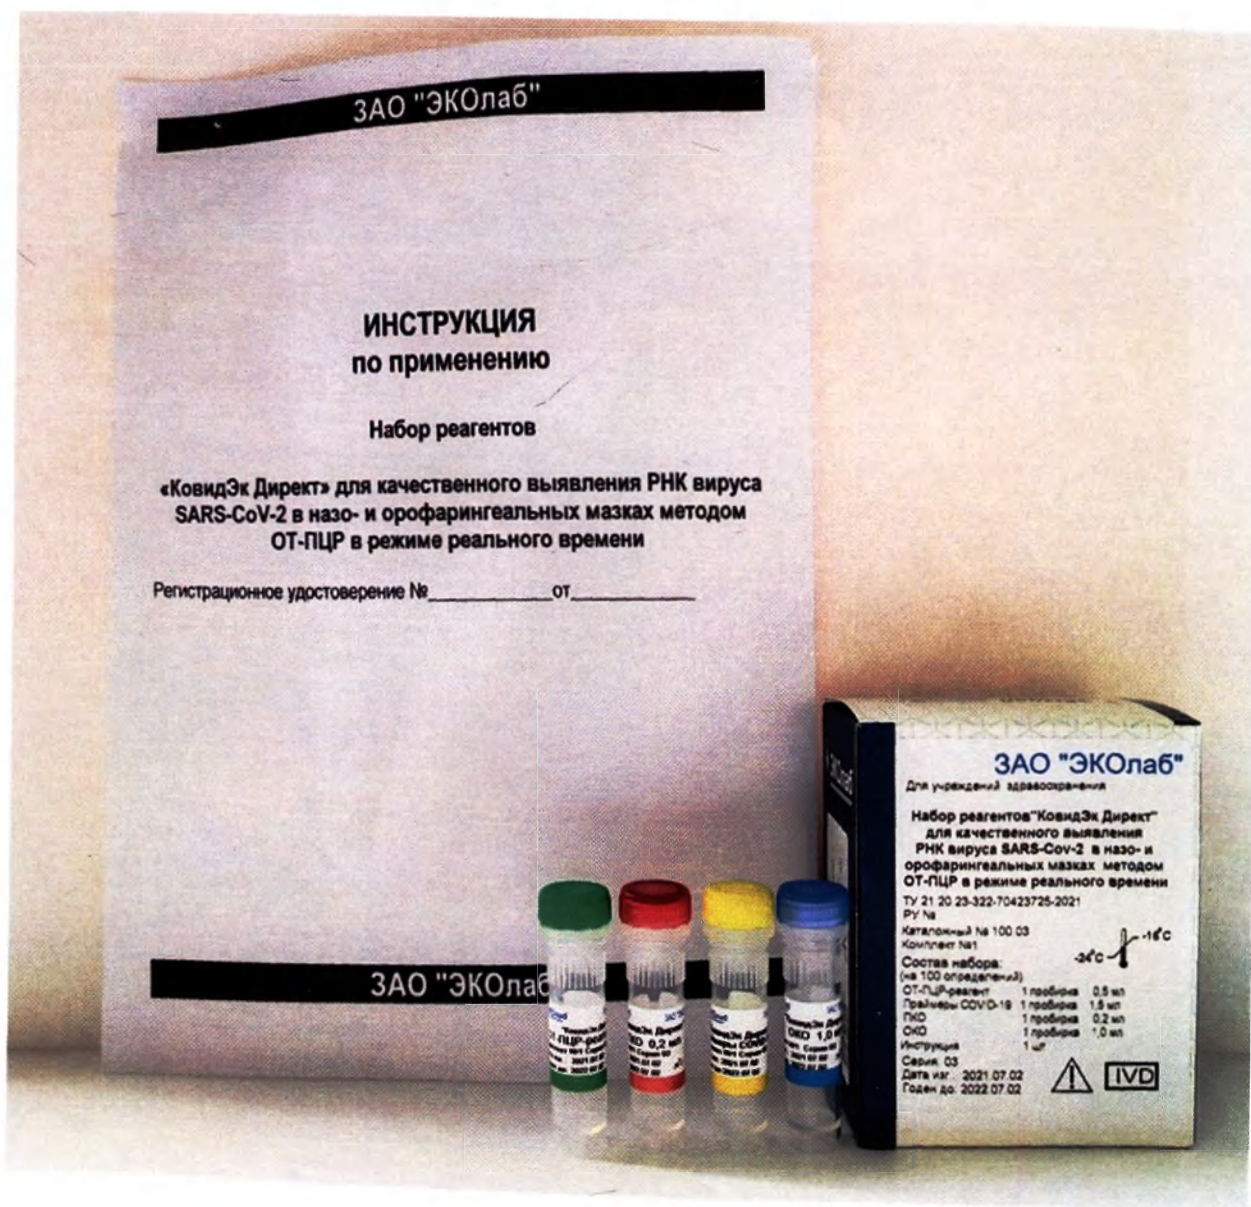


Фото открытой коробки ( вид сверху) набора реагентов «КовидЭк Директ»

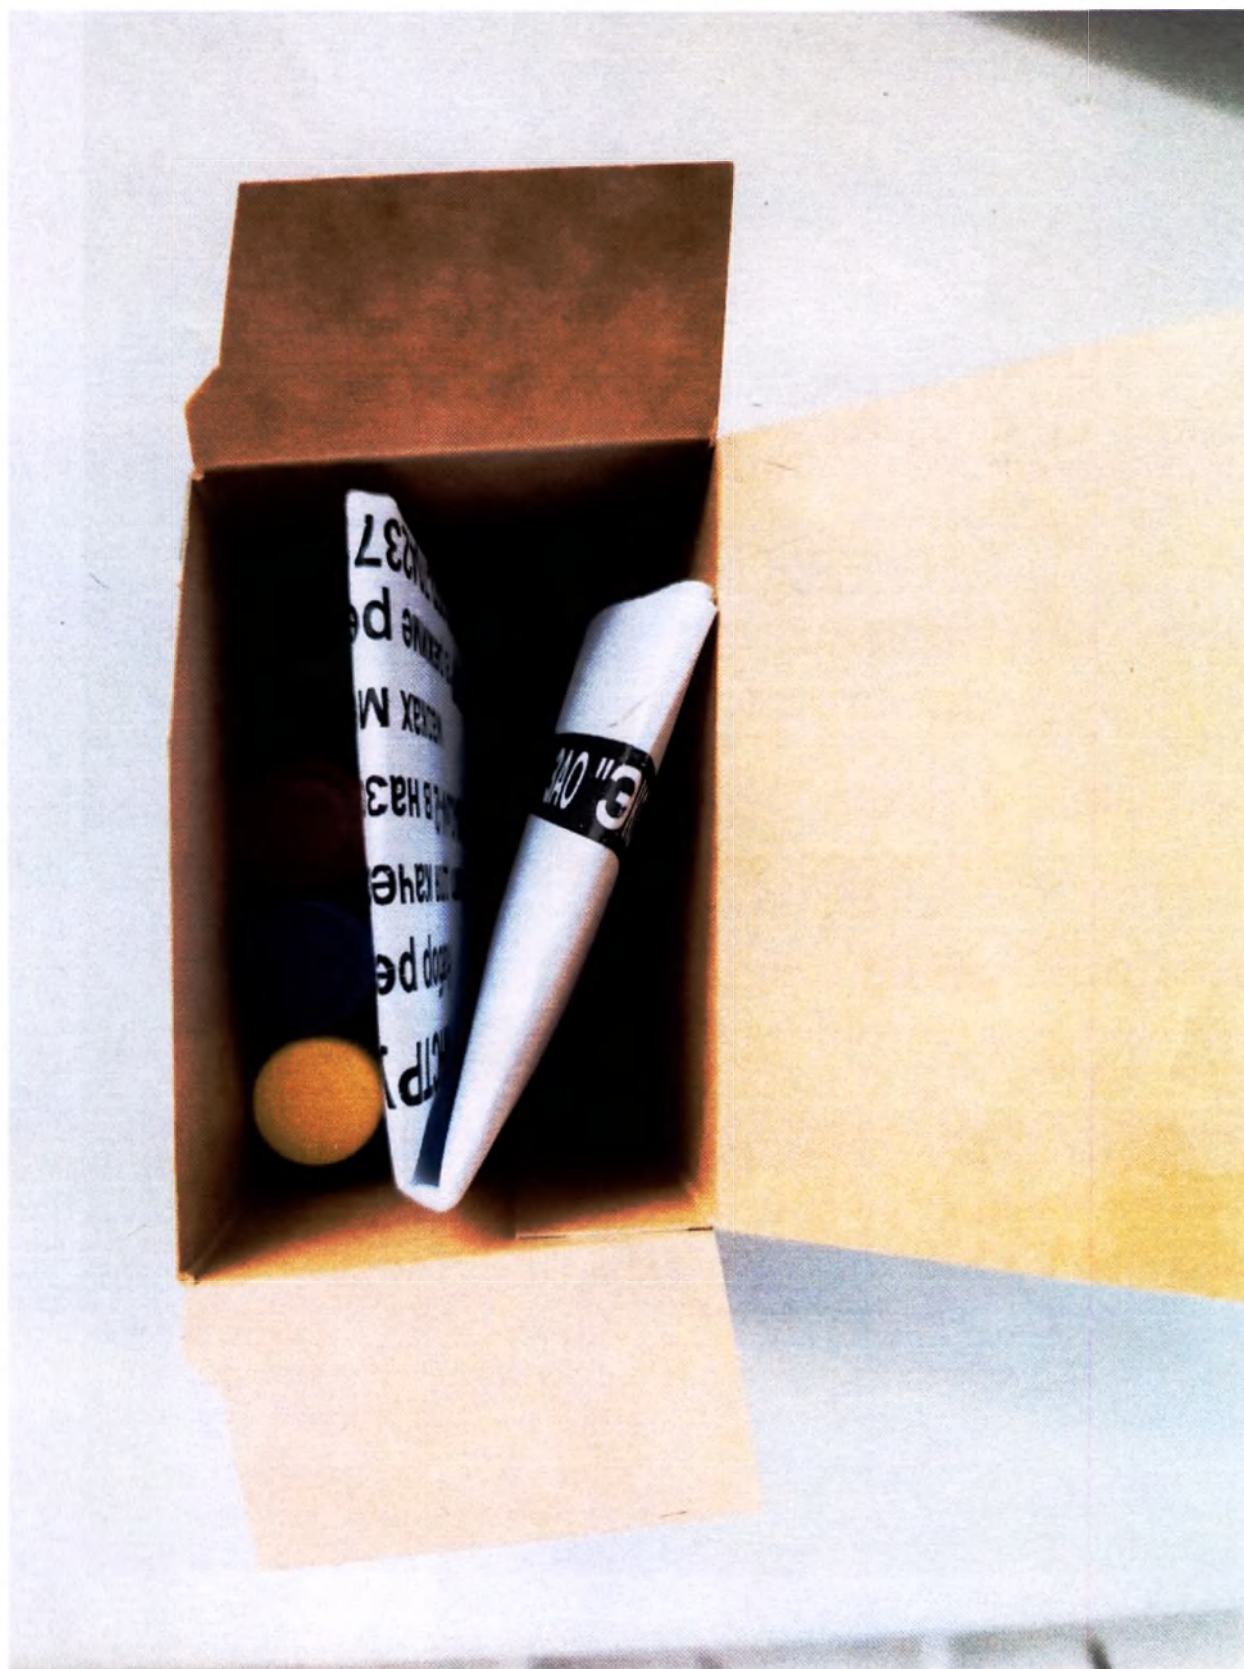


Фото коробки набора реагентов «КовидЭк Директ»

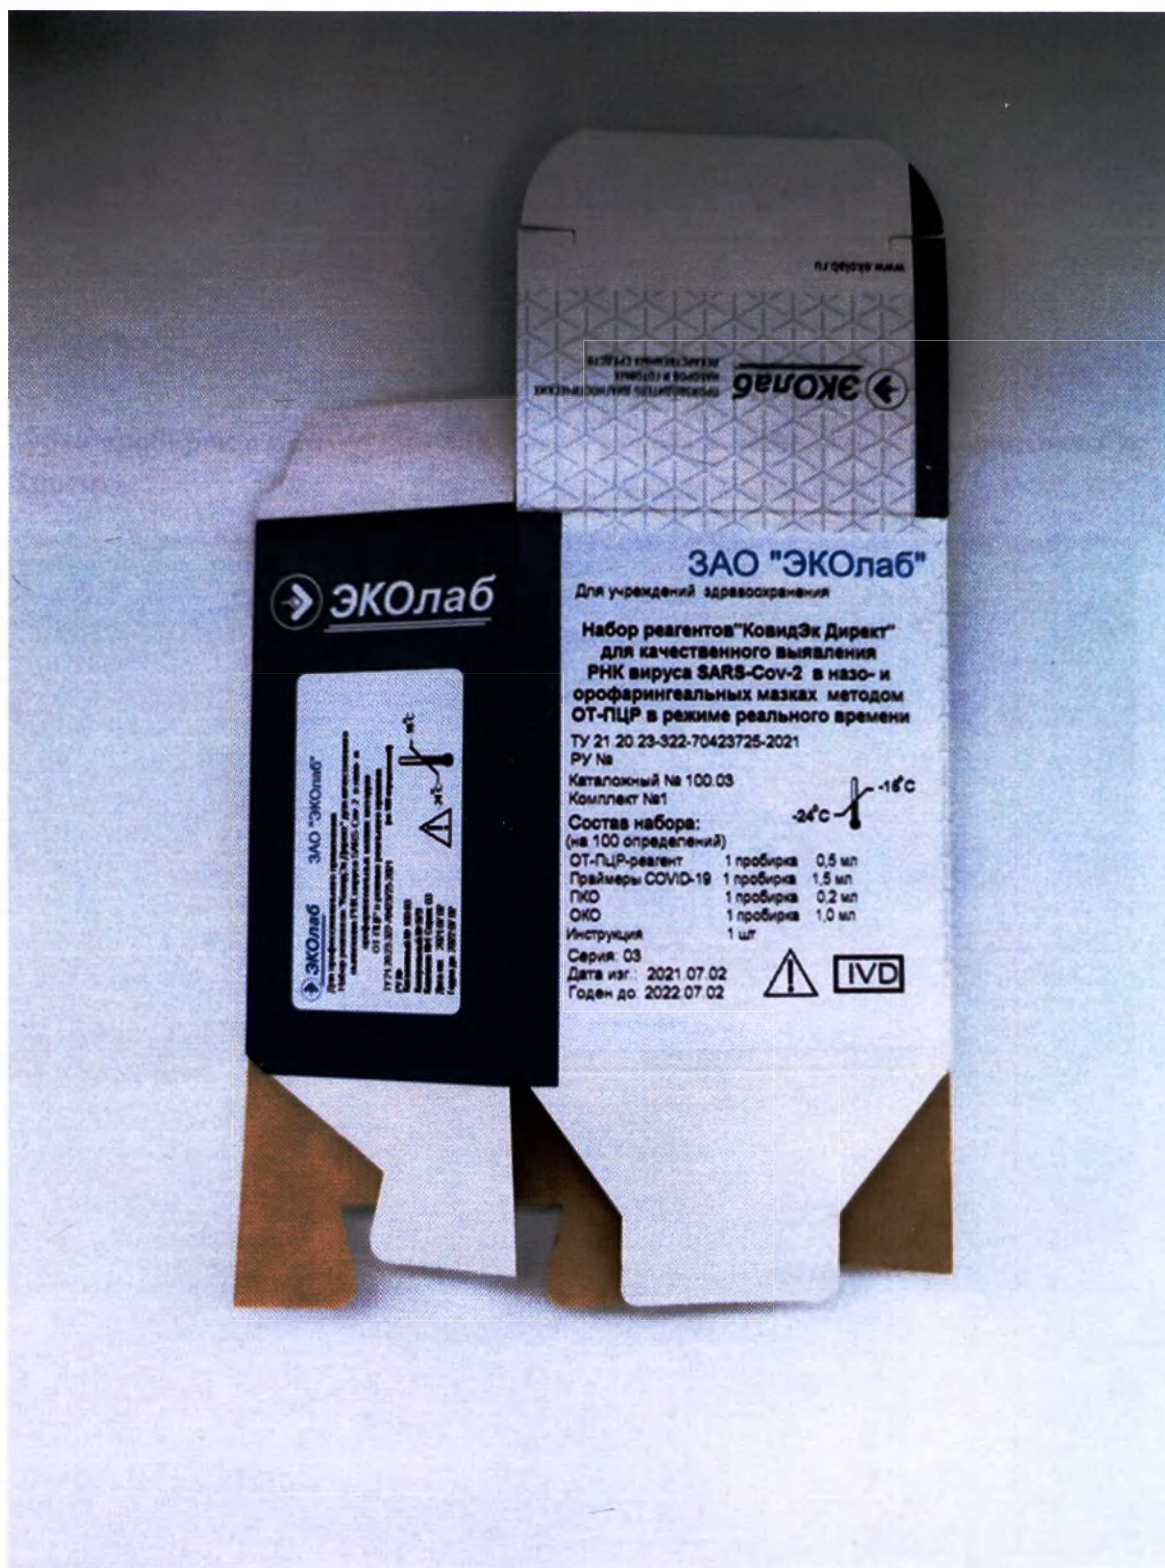


Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»



Серия 05 от 2021.07.05

Общий вид набора реагентов «КовидЭк Директ»

ЗАО "ЭКОлаб"

## ИНСТРУКЦИЯ по применению

Набор реагентов

«КовидЭк Директ» для качественного выявления РНК вируса  
SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ЗАО "ЭКОлаб"



ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов "КовидЭк Директ"  
для качественного выявления  
РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21 20 23-322-70423725-2021

Ру №

Каталожный № 100 03

Комплект №1

Состав набора:

(на 100 определений)

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,5 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОНО 1 пробирка 1,0 мл


Инструкция 1 шт

Серия: 05

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05

-16°C  
-24°C



Вид сверху открытой коробки набора реагентов «КовидЭк Директ»

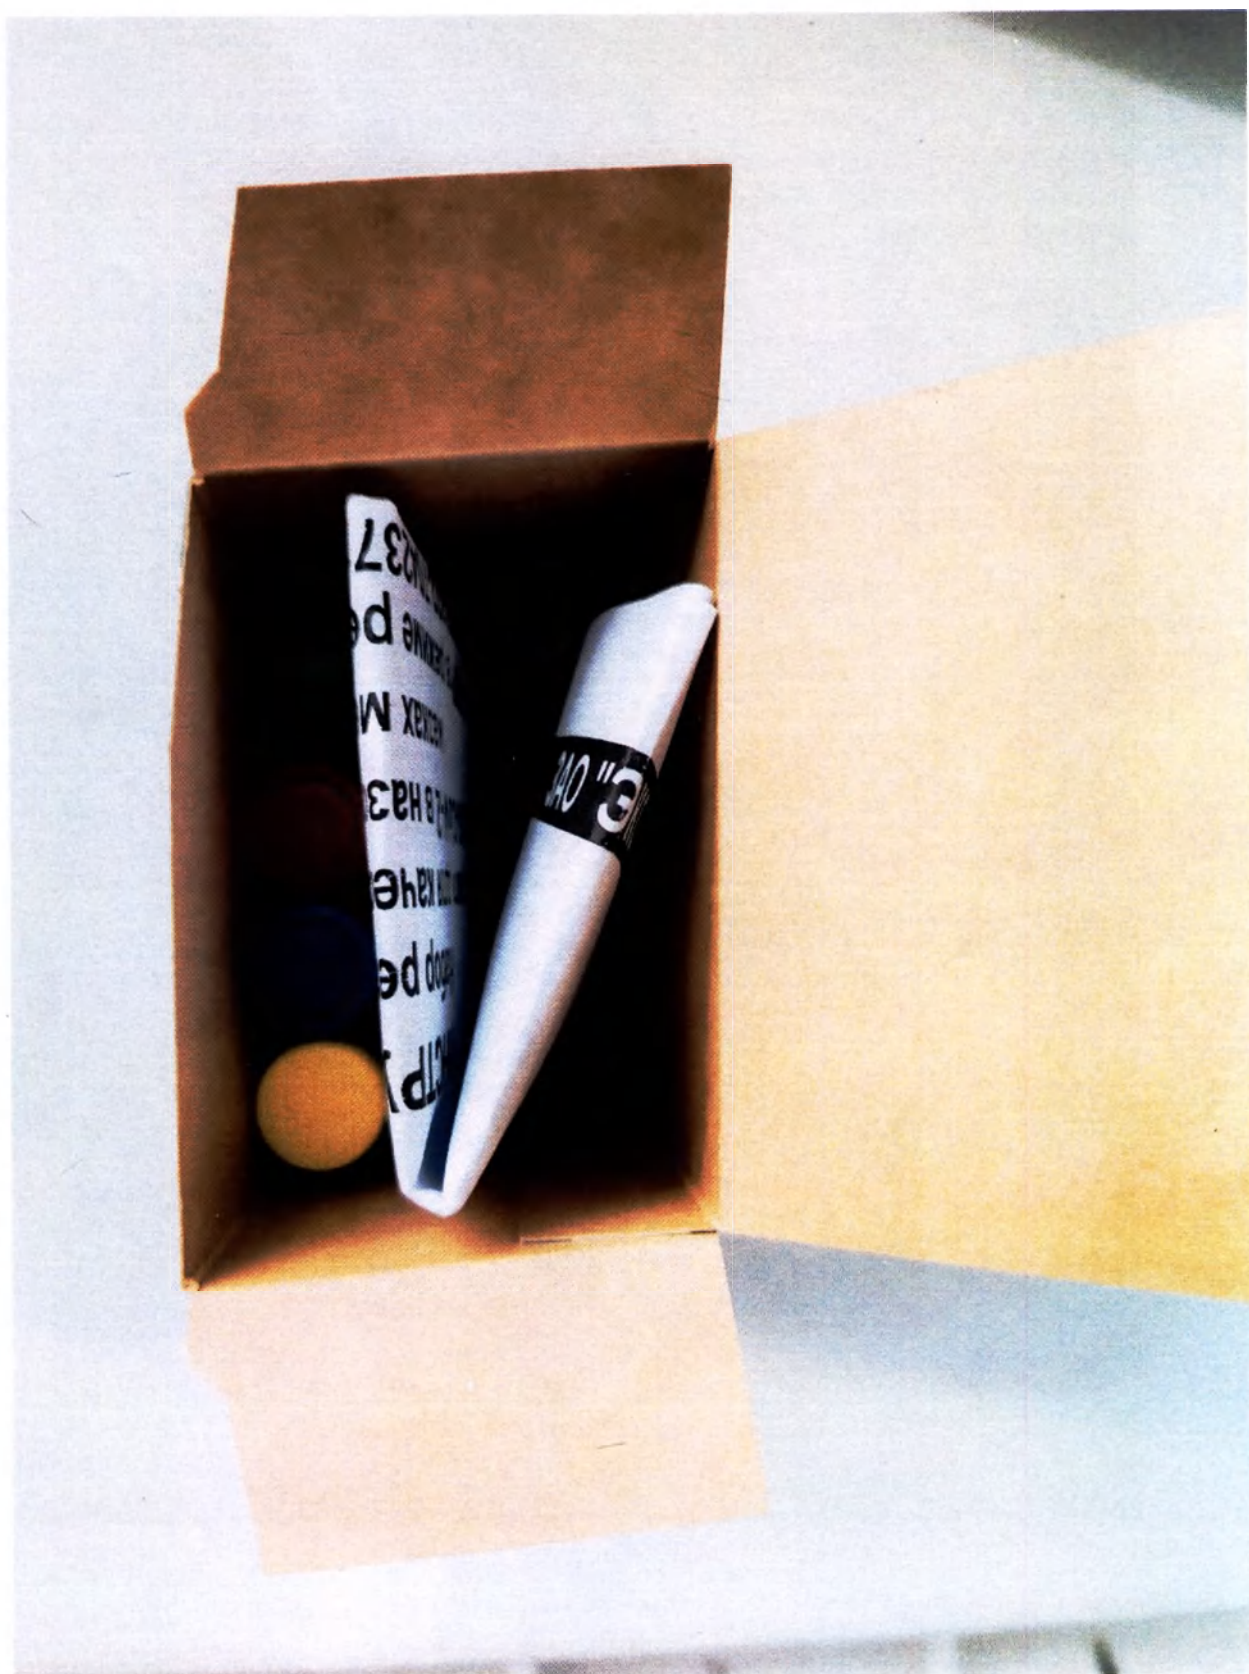


Фото коробки набора реагентов «КовидЭк Директ»


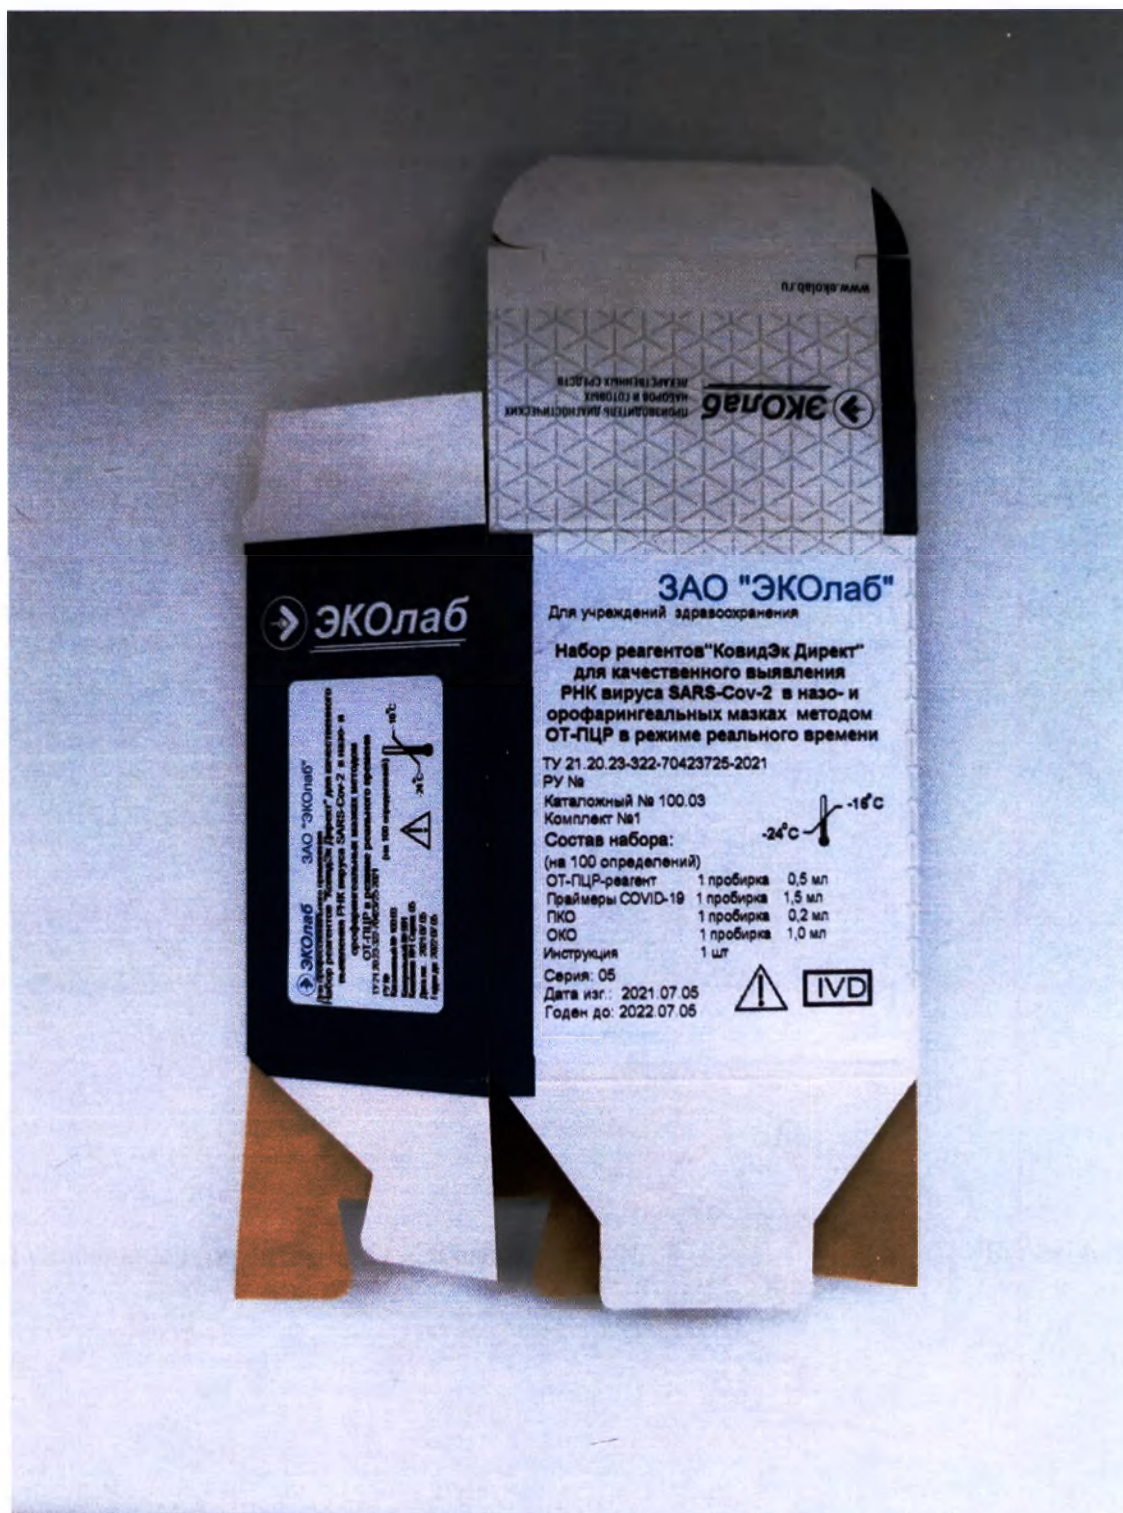


Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»



Генеральный директор ЗАО «ЭкоЛаб»

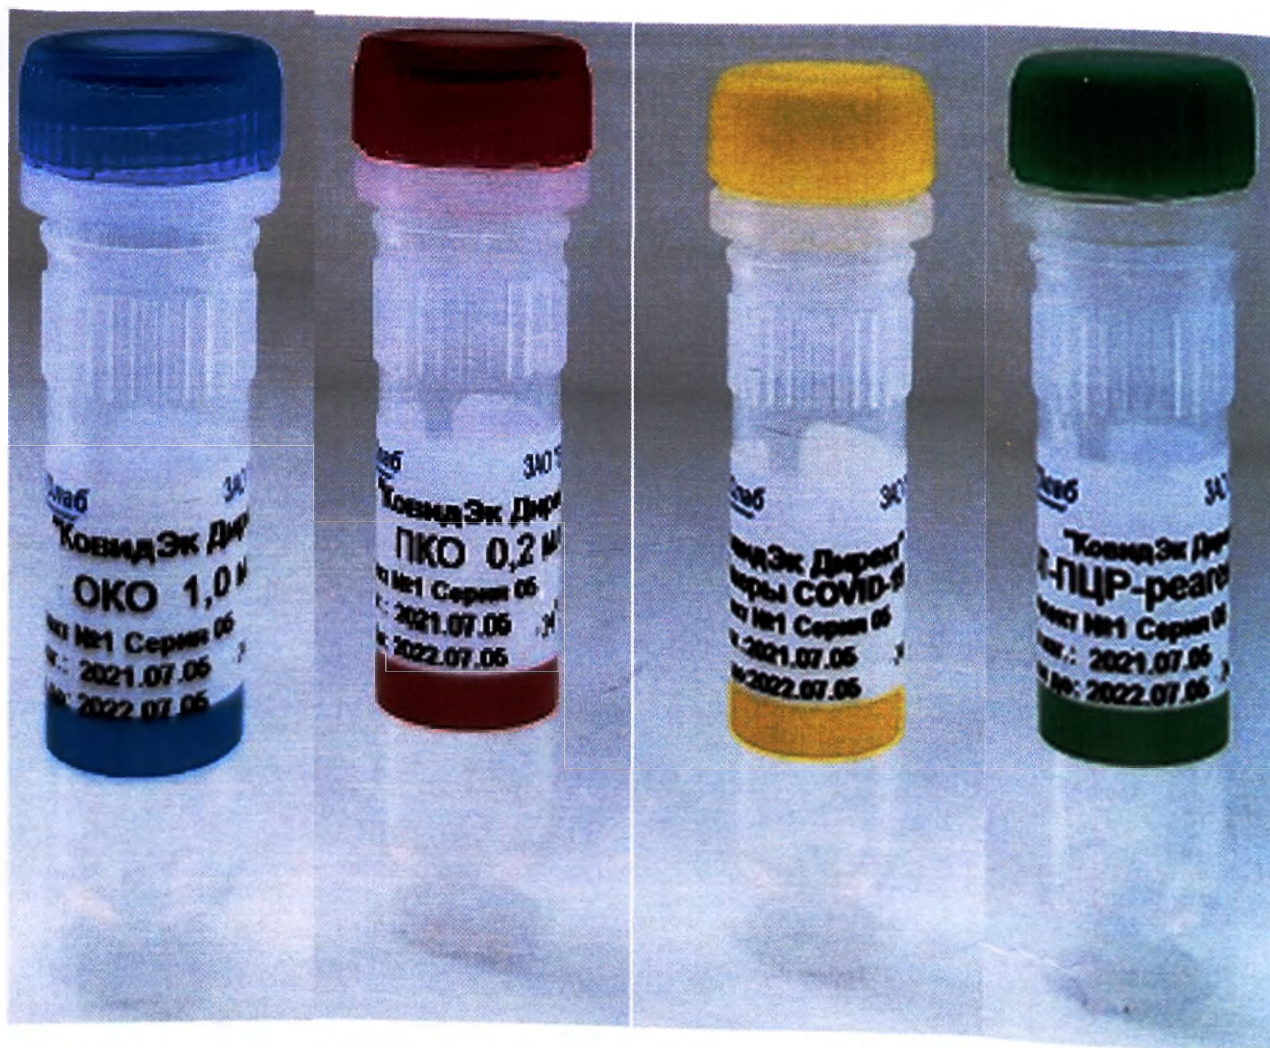


Борисов В.Ю.

**Фотографические изображения общего вида  
Набора реагентов  
«КовидЭк Директ» для качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени.**

**Комплект №2**

**Серия 04 от 2021.07.02**


**Общий вид набора реагентов «КовидЭк Директ»**

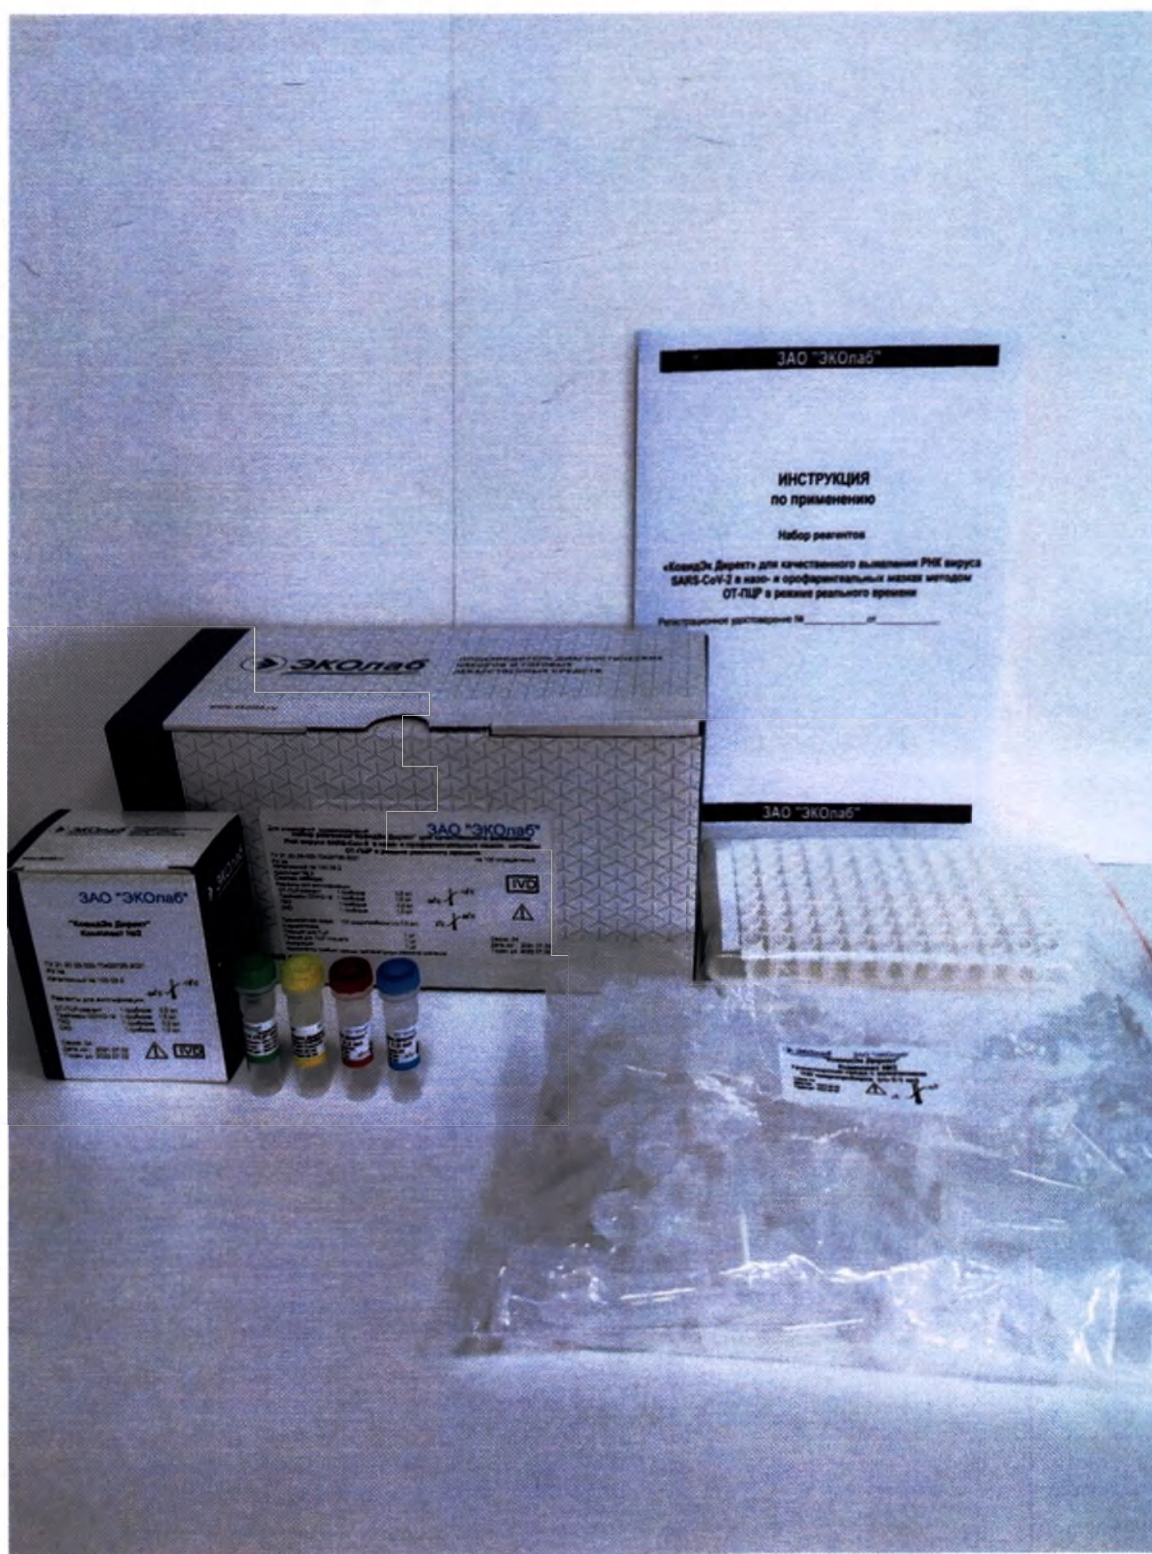

Вид сверху открытой коробки набора реагентов «КовидЭк Директ»



**Фото открытой коробки ( вид сверху) с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»**

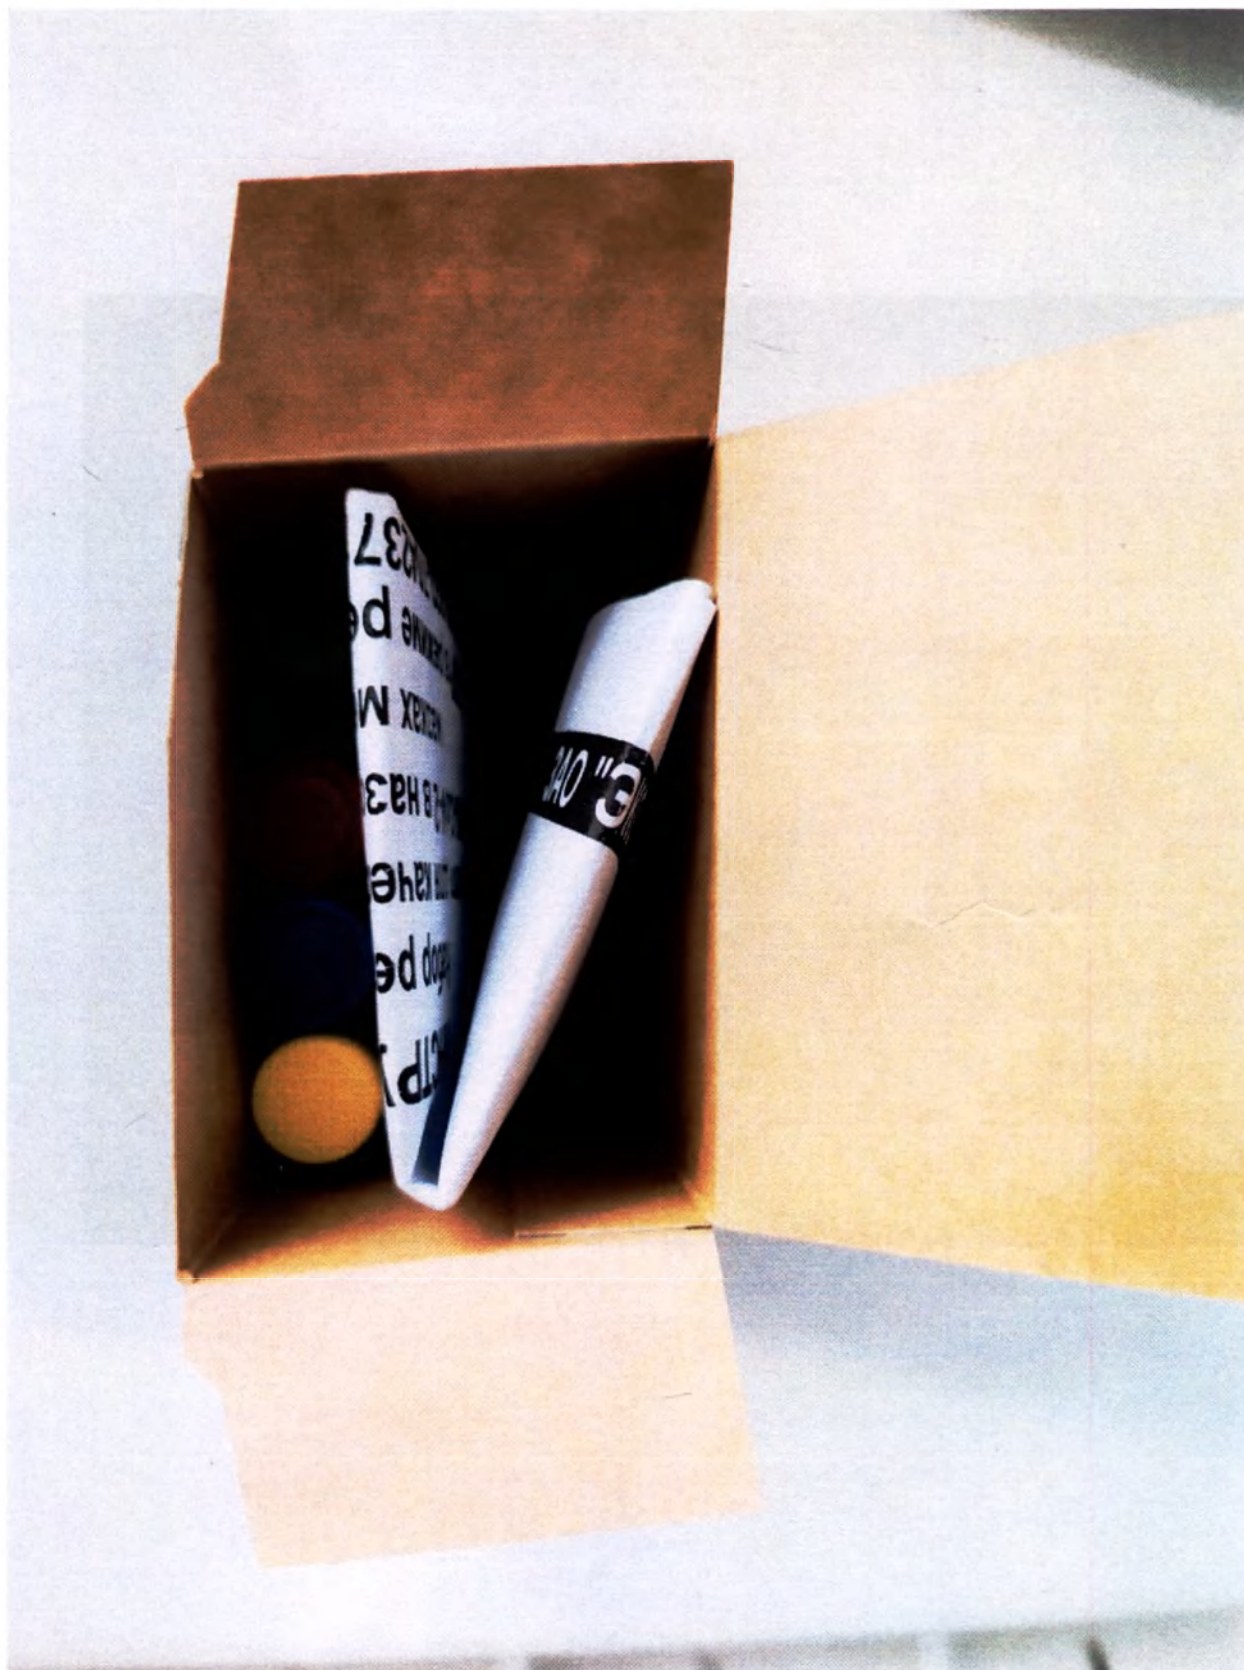

**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк Директ» и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»**

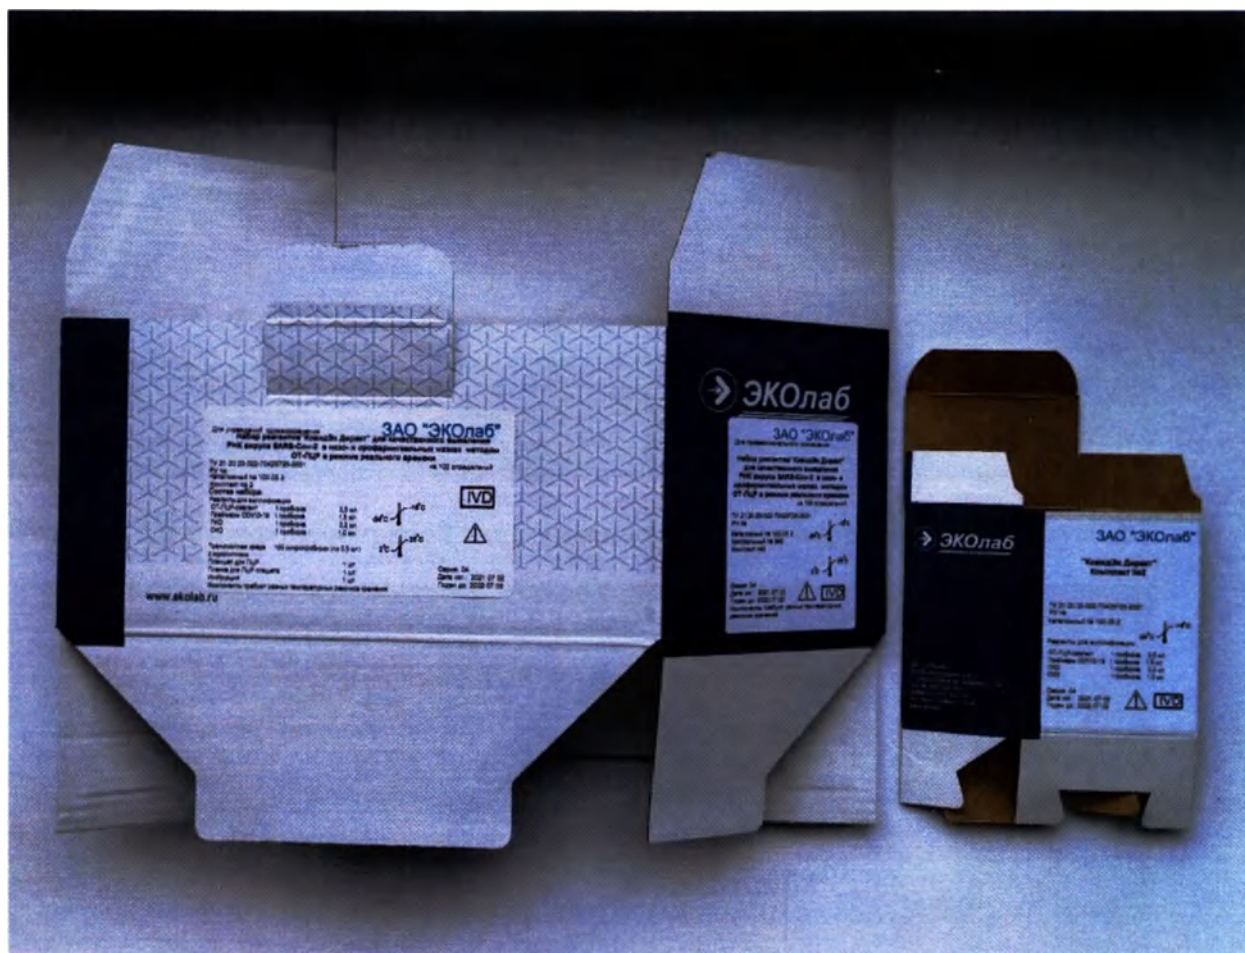


Фото пакета с планшетом для ПЦР и пленкой для ПЦР планшета

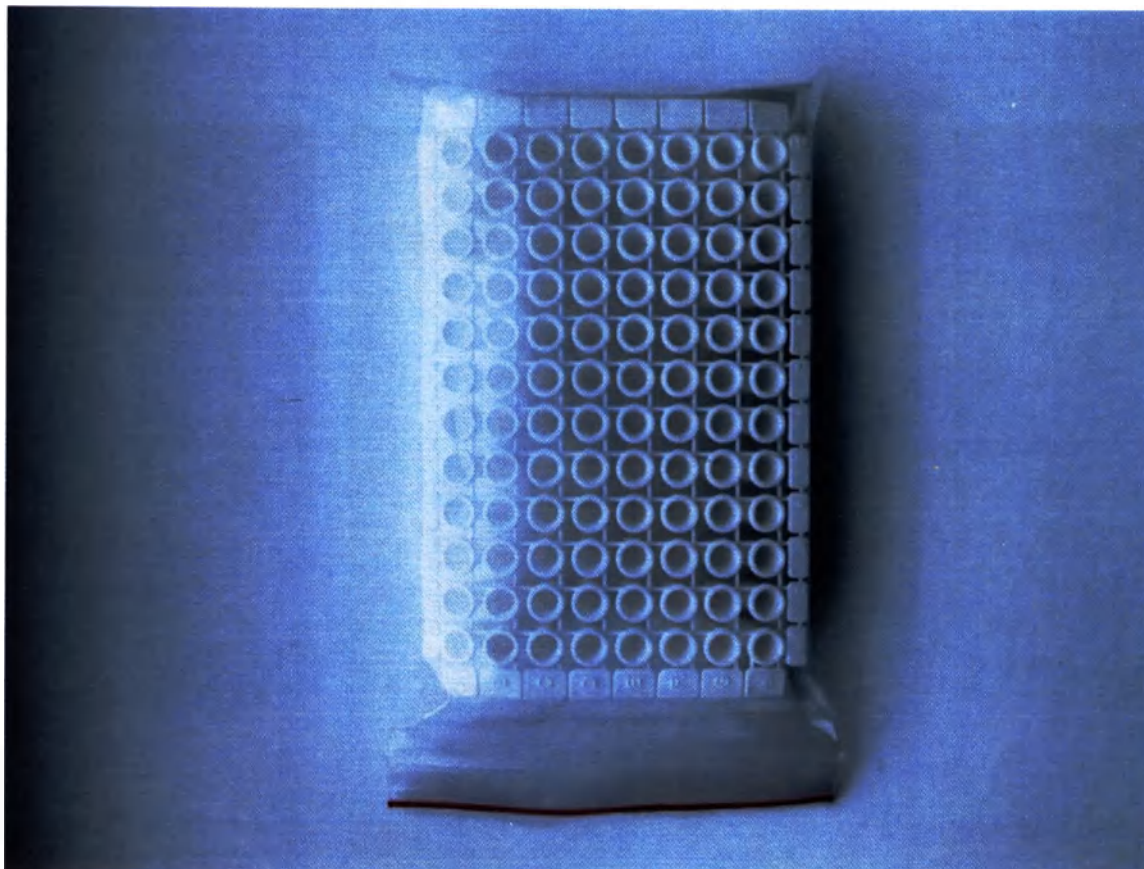


Фото пакета с микропробирками типа Эппендорф с транспортной средой с муколитиком



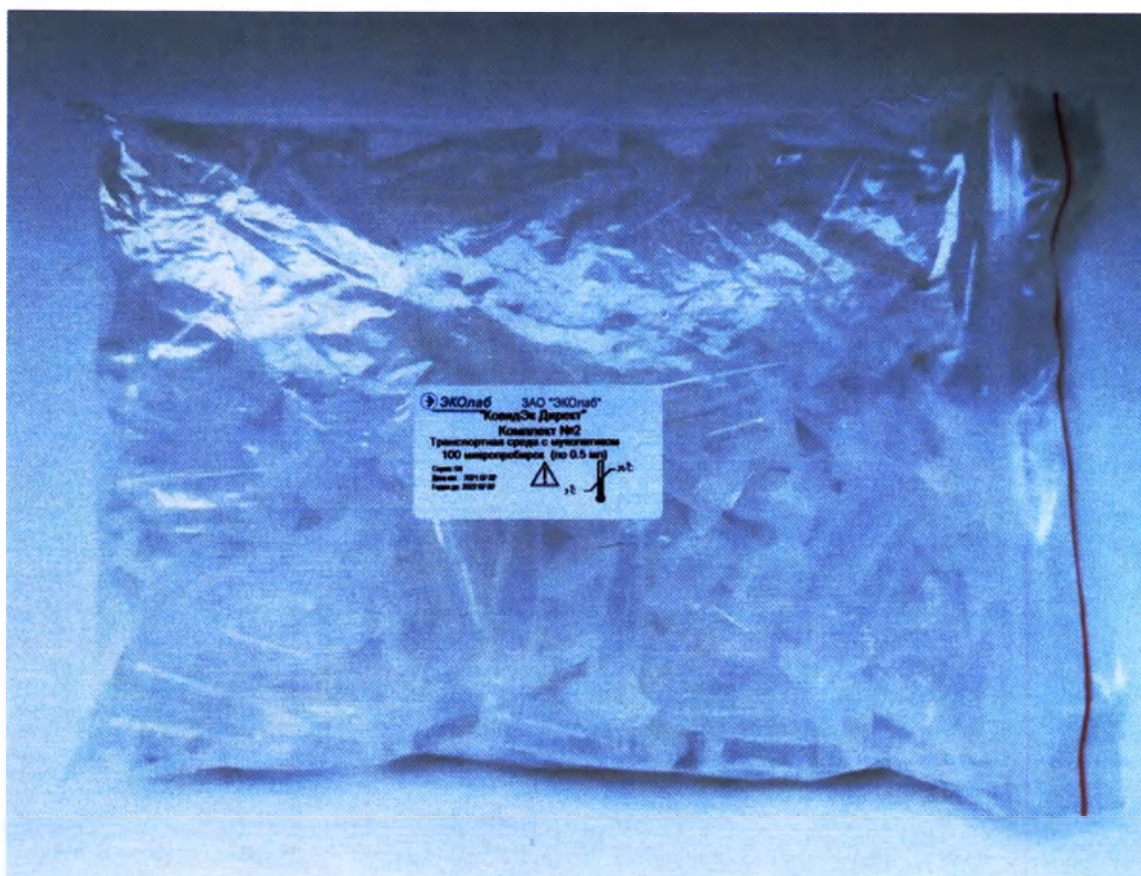


Фото пробирок с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»

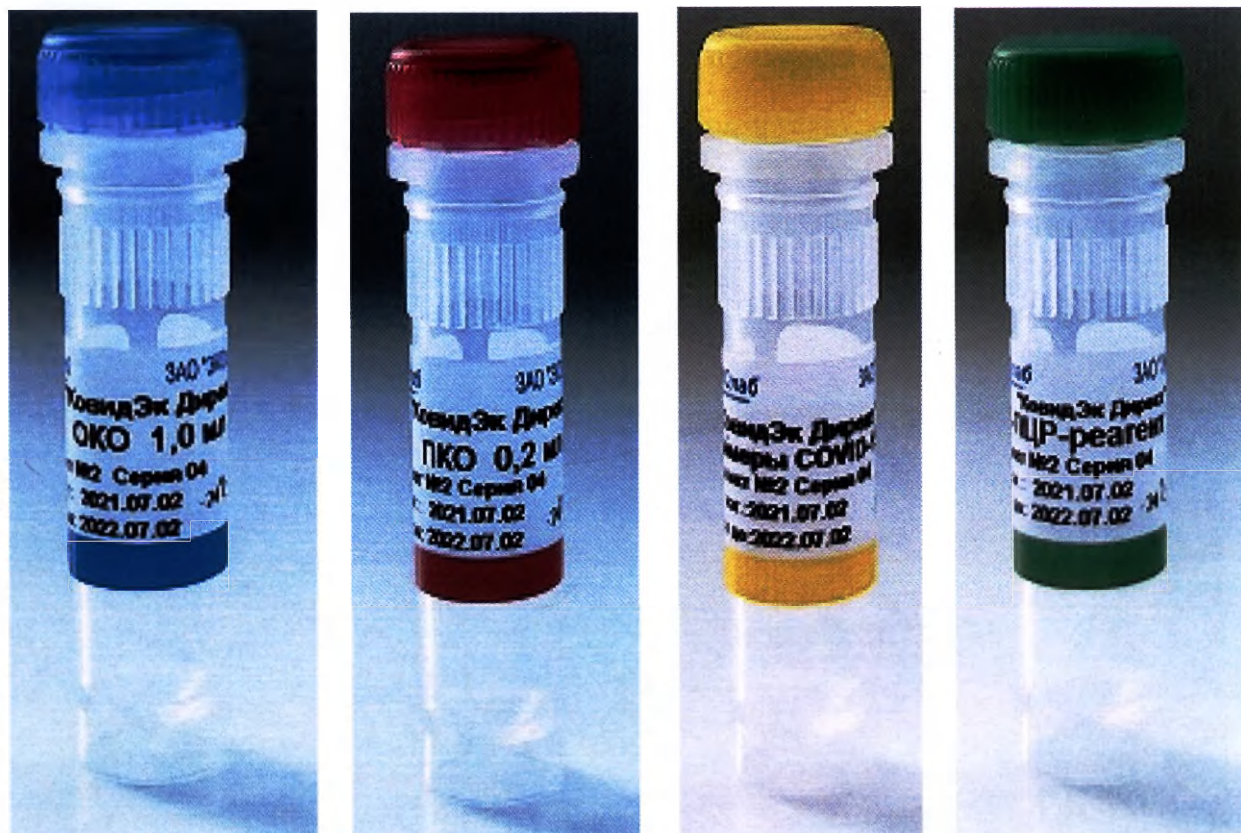

Серия 06 от 2021.07.05


Общий вид набора реагентов «КовидЭк Директ»

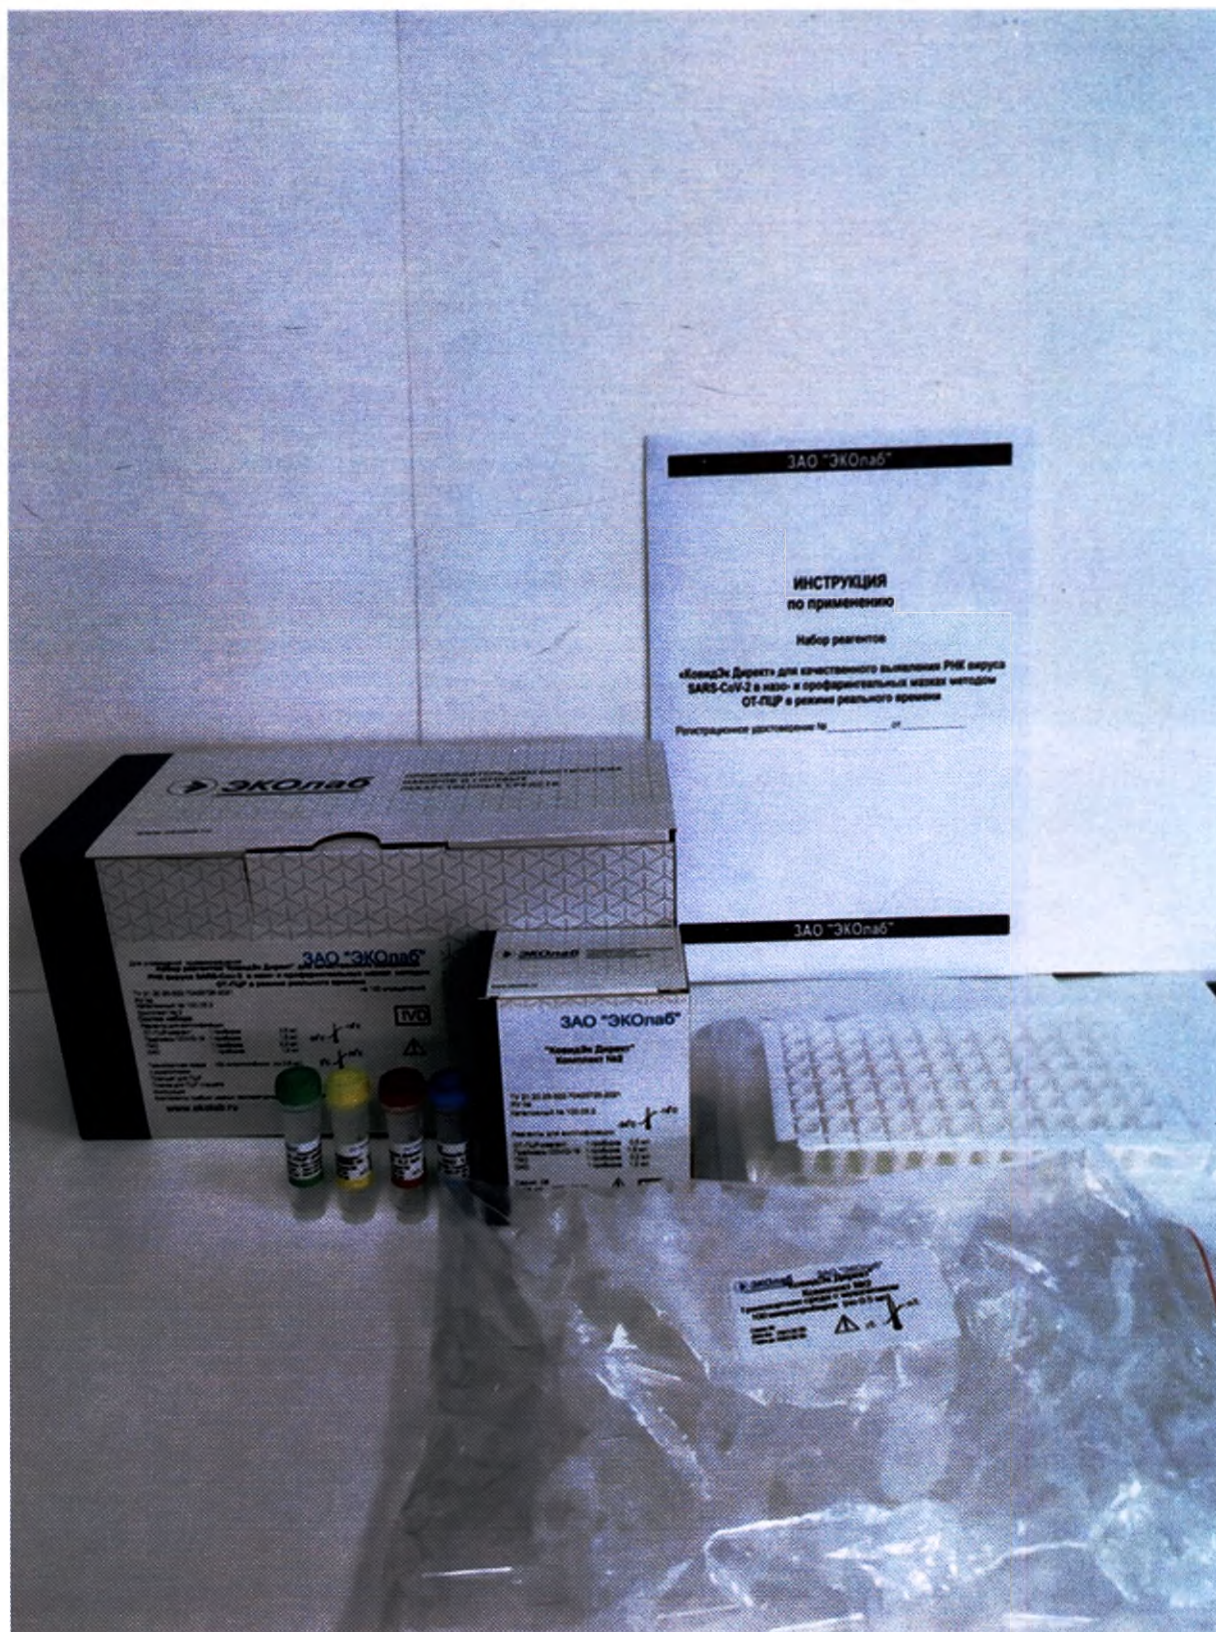

Вид сверху открытой коробки набора реагентов «КовидЭк Директ»



Фото открытой коробки (вид сверху) с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»

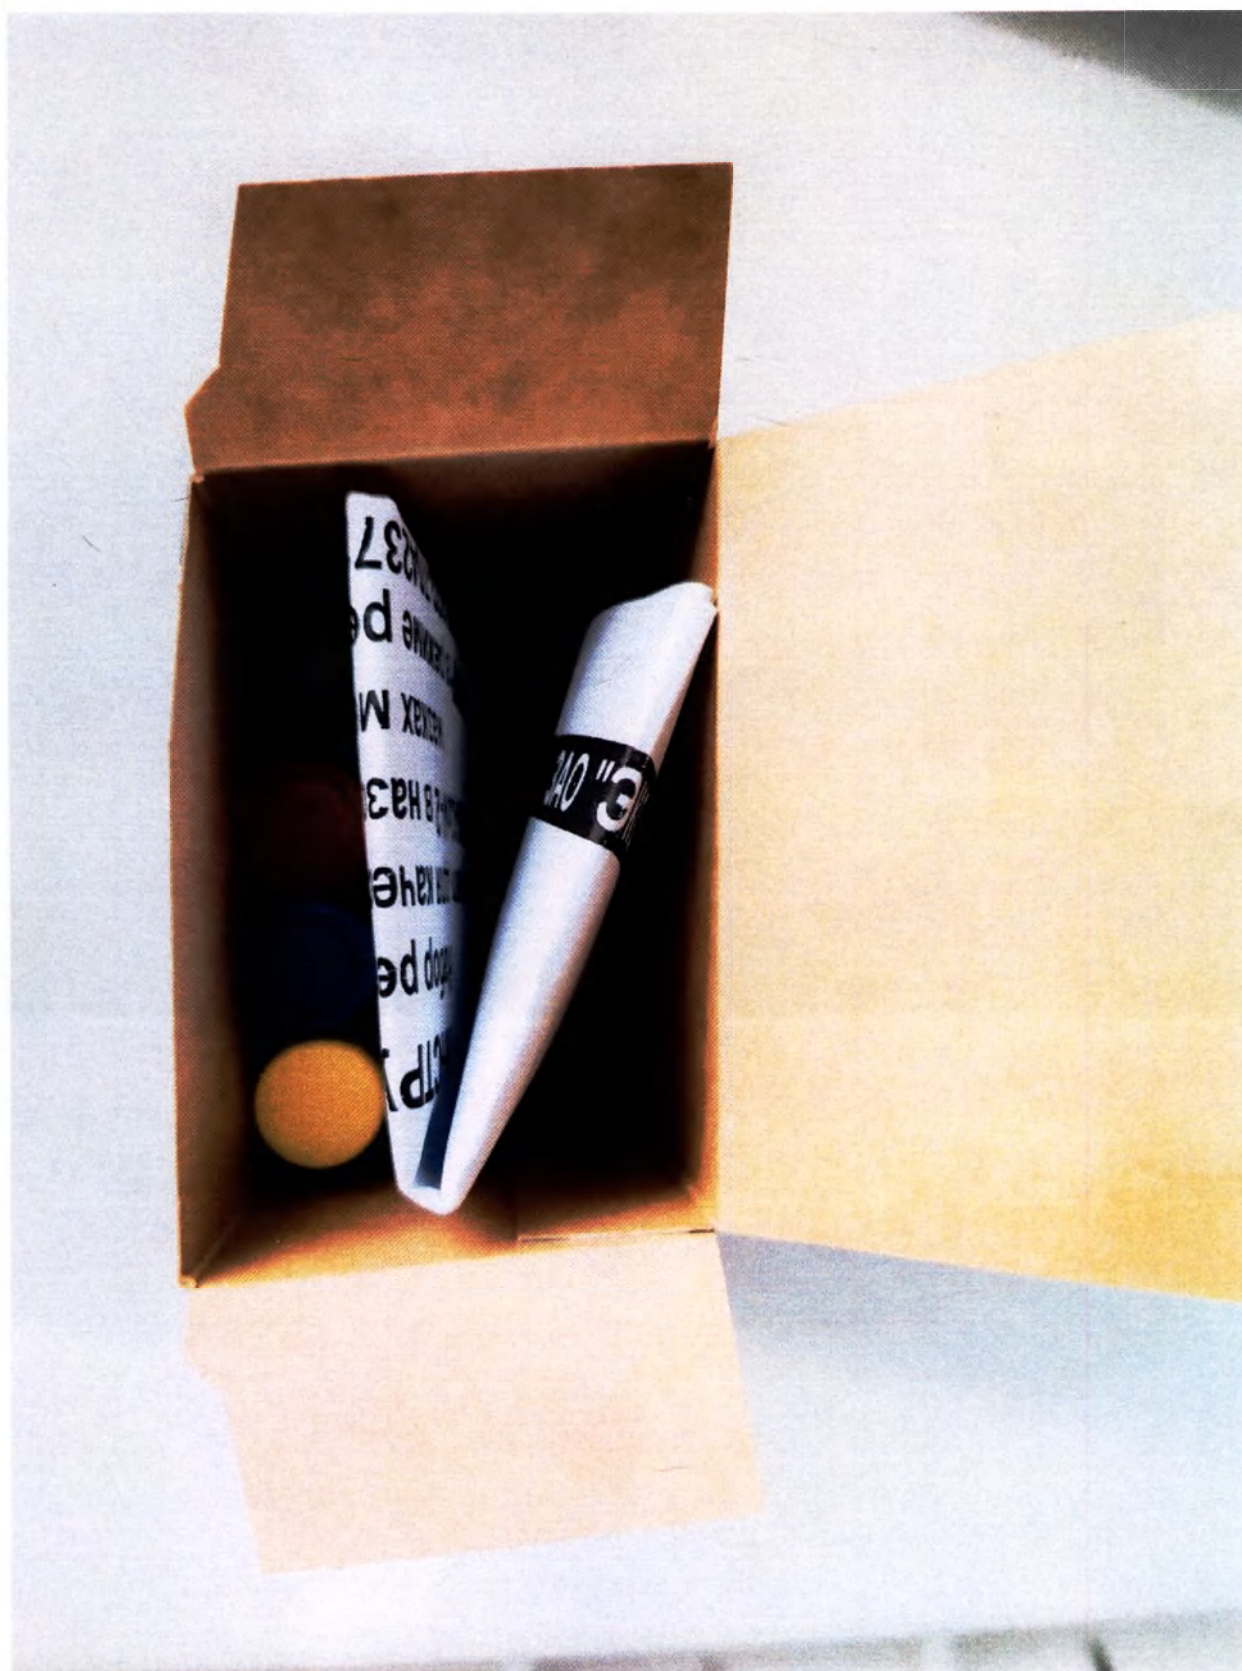

**Фото коробки набора реагентов «КовидЭк Директ» и коробки с реагентами для амплификации набора реагентов «КовидЭк Директ»**

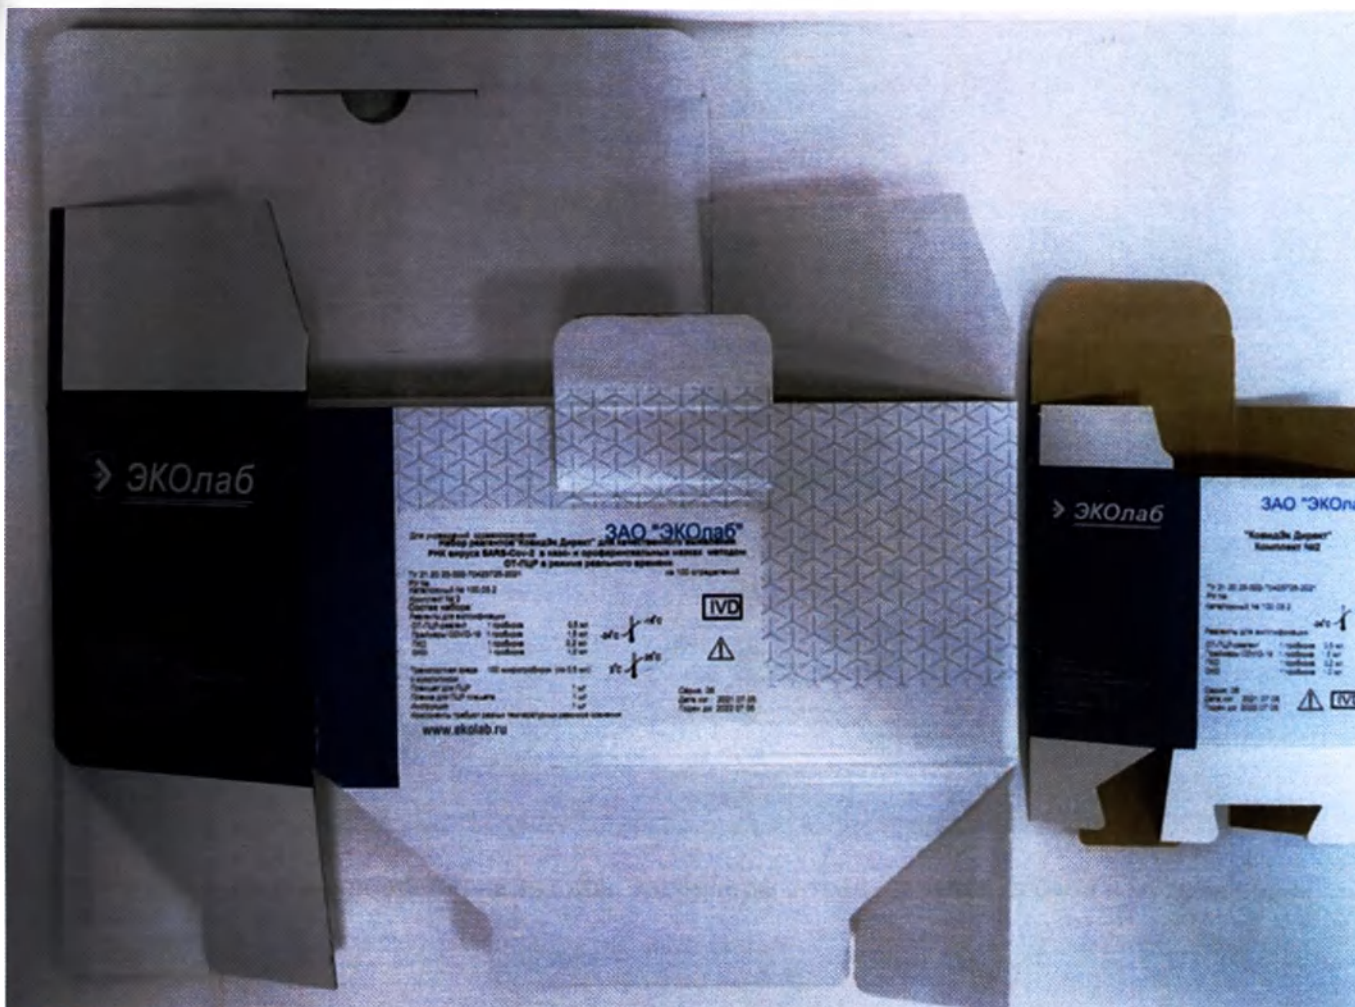


Фото пакета с планшетом для ПЦР и пленкой для ПЦР планшета


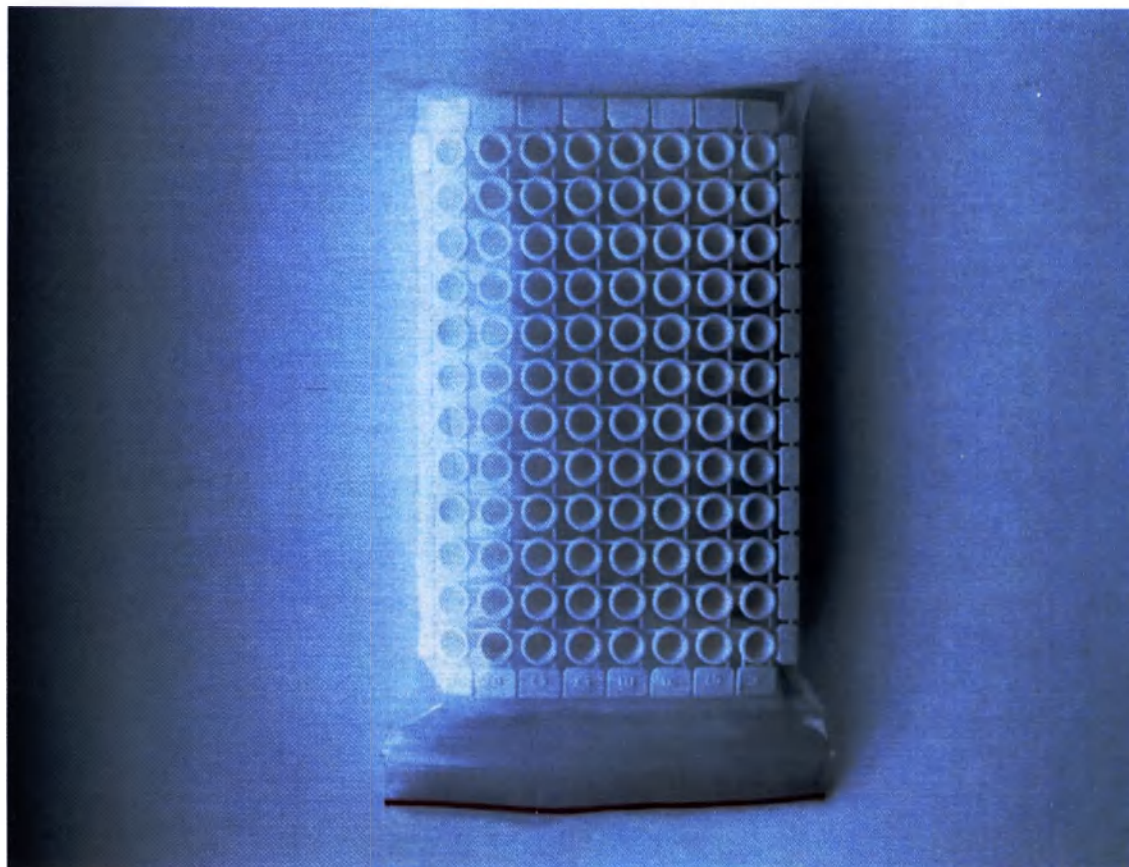


Фото пакета с микропробирками типа Эппендорф с транспортной средой с муколитиком

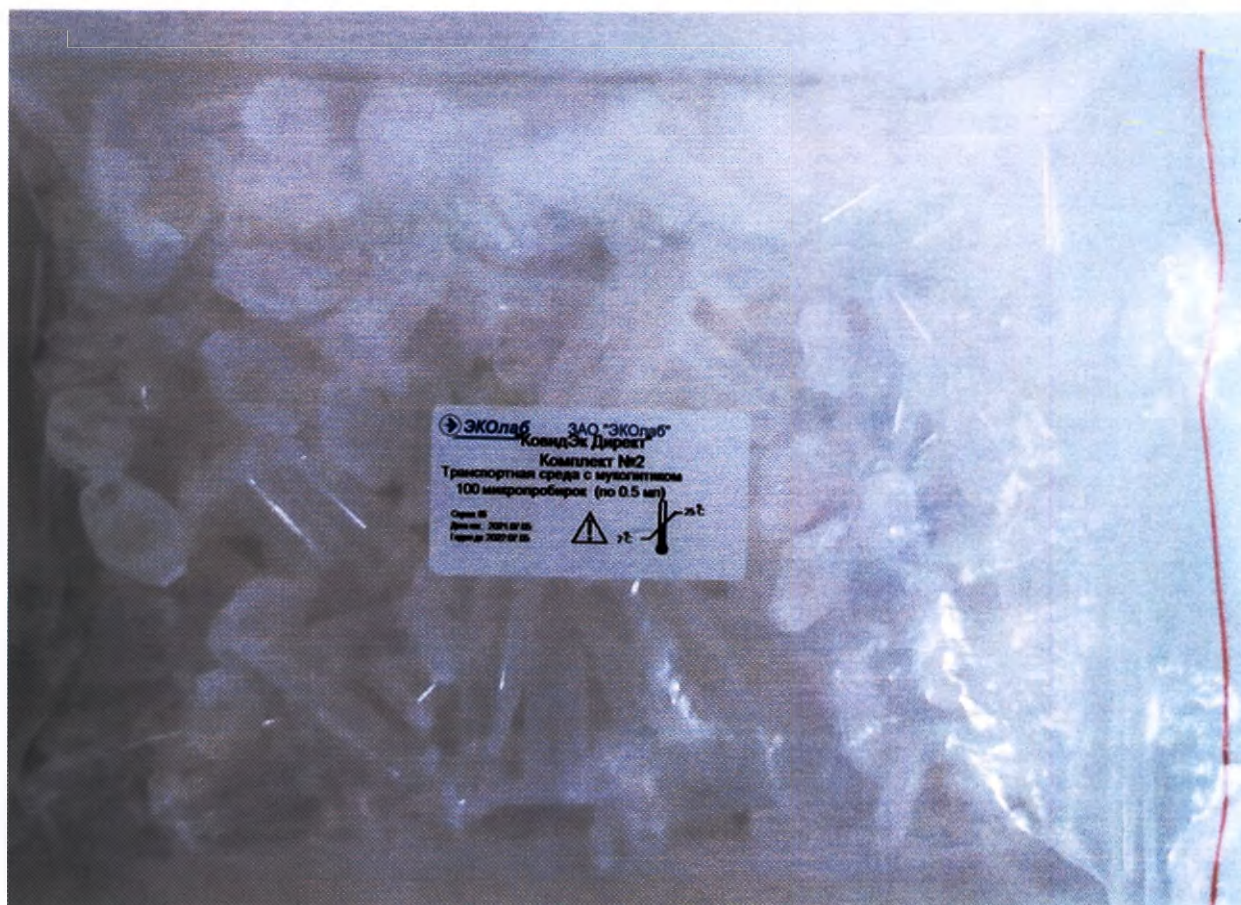

The image displays four vials of PCR reagents for COVID-19 detection, arranged side-by-side. Each vial has a different colored cap and a label with the following text: "3AO '3AO'", "МДЭк Директ", "COVID-19", "ПКО 0,2 мл", "2021.07.05", "2022.07.05", and "2021.07.05". The vials are labeled as follows: 1. Green cap, green label, "ПКО 0,2 мл". 2. Yellow cap, yellow label, "ПКО 0,2 мл". 3. Red cap, red label, "ПКО 0,2 мл". 4. Blue cap, blue label, "ПКО 1,0 мл".

 ООО ЦПМИ  INFO@CPMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

и скреплено печатью  
20 ЛИСТ 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб" Гашенко Т.Ю.  
2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



## ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

**Набор реагентов "КовидЭк Директ"**  
для качественного выявления  
РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени

TU 21.20.23-322-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.03

Комплект №1

Состав набора:

(на 100 определений)

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,5 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл







ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Инструкция 1 шт.

Серия: 03

Дата изг.: 2021.07.02

Годен до: 2022.07.02



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики», указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР

М.С. Войков

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»  
В.Ю. Борисов  
2021 год.



Для учреждений здравоохранения  
**ЗАО "ЭКОлаб"**  
Набор реагентов "КовидЭк Директ" для качественного выявления  
РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
на 100 определений


ТУ 21.20.23-322-70423725-2021  
РУ №  
Каталожный № 100.03.2  
Комплект № 2  
Состав набора:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Реагенты для амплификации |                   |
| ОТ-ПЦР-реагент            | 1 пробирка 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19         | 1 пробирка 1,5 мл |
| ПКО                       | 1 пробирка 0,2 мл |
| ОКО                       | 1 пробирка 1,0 мл |

Транспортная среда 100 микропробирок (по 0,5 мл)

с муконитиком  
Планишет для ПЦР 1 шт  
Пленка для ПЦР планшета 1 шт  
Инструкция 1 шт

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения





Серия: 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02

Для профессионального применения  
**ЗАО "ЭКОлаб"**

Набор реагентов "КовидЭк Директ"  
для качественного выявления  
РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
на 100 определений

ТУ 21.20.23-322-70423725-2021  
РУ №  
Каталожный № 100.03.2  
Контрольный № 980  
Комплект №2




Серия: 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02  
Компоненты требуют разных температурных режимов хранения

**ЗАО "ЭКОлаб"**

"КовидЭк Директ"  
Комплект №2

**ЗАО "ЭКОлаб"**  
"КовидЭк Директ"  
Комплект №2  
Транспортная среда с муконитиком  
100 микропробирок (по 0,5 мл)

Серия: 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02




ТУ 21.20.23-322-70423725-2021  
РУ №  
Каталожный № 100.03.2

Реагенты для амплификации:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ОТ-ПЦР-реагент    | 1 пробирка 0,5 мл |
| Праймеры COVID-19 | 1 пробирка 1,5 мл |
| ПКО               | 1 пробирка 0,2 мл |
| ОКО               | 1 пробирка 1,0 мл |

Серия: 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02



**ЗАО "ЭКОлаб"**  
"КовидЭк Директ"  
ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл  
Комплект №2 Серия 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02

**ЗАО "ЭКОлаб"**  
"КовидЭк Директ"  
Праймеры COVID-19 1,5 мл  
Комплект №2 Серия 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02

**ЗАО "ЭКОлаб"**  
"КовидЭк Директ"  
ПКО 0,2 мл  
Комплект №2 Серия 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02

**ЗАО "ЭКОлаб"**  
"КовидЭк Директ"  
ОКО 1,0 мл  
Комплект №2 Серия 04  
Дата изг.: 2021.07.02  
Годен до: 2022.07.02

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики», указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР

М.С. Войков

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



## ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

**Набор реагентов "КовидЭк Директ"**  
для качественного выявления  
РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени

ТУ 21.20.23-322-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.03

Комплект №1

Состав набора:

(на 100 определений)

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,5 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Инструкция 1 шт

Серия: 05

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05

-24°C



IVD

ЗАО "ЭКОлаб"  
"КовидЭк Директ"  
ОКО 1,0 мл  
Комплект №1 Серия 05  
Дата изг.: 2021.07.05  
Годен до: 2022.07.05

ЗАО "ЭКОлаб"  
"КовидЭк Директ"  
ПКО 0,2 мл  
Комплект №1 Серия 05  
Дата изг.: 2021.07.05  
Годен до: 2022.07.05

ЗАО "ЭКОлаб"  
"КовидЭк Директ"  
ОТ-ПЦР-реагент 0,5 мл  
Комплект №1 Серия 05  
Дата изг.: 2021.07.05  
Годен до: 2022.07.05

ЗАО "ЭКОлаб"  
"КовидЭк Директ"  
Праймеры COVID-19 1,5 мл  
Комплект №1 Серия 05  
Дата изг.: 2021.07.05  
Годен до: 2022.07.05

ЗАО "ЭКОлаб"  
Для учреждений здравоохранения  
Набор реагентов "КовидЭк Директ" для качественного  
выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и  
орофарингеальных мазках методом  
ОТ-ПЦР в режиме реального времени  
ТУ 21.20.23-322-70423725-2021  
(на 100 определений)  
РУ №  
Каталожный № 100.03  
Комплект №1 Серия 05  
Дата изг.: 2021.07.05  
Годен до: 2022.07.05

-24°C



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики», указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР

М.С. Войков

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Набор реагентов "КовидЭк Директ" для качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени на 100 определений


ТУ 21.20.23-322-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.03.2

Контрольный № 992

Комплект №2



Серия: 06

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



ЗАО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов "КовидЭк Директ" для качественного выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в назо- и орофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени на 100 определений

ТУ 21.20.23-322-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.03.2

Комплект № 2

Состав набора:

Реагенты для амплификации

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,5 мл

ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Транспортная среда 100 микропробирок (по 0,5 мл)


с муконитом

Пластины для ПЦР 1 шт

Пленка для ПЦР-плашета 1 шт

Инструкция 1 шт

Компоненты требуют разных температурных режимов хранения



Серия: 06

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05

ЗАО "ЭКОлаб"

"КовидЭк Директ"  
Комплект №2

ТУ 21.20.23-322-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 100.03.2

Реагенты для амплификации:

ОТ-ПЦР-реагент 1 пробирка 0,5 мл

Праймеры COVID-19 1 пробирка 1,5 мл


ПКО 1 пробирка 0,2 мл

ОКО 1 пробирка 1,0 мл

Серия: 06

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05








ЗАО "ЭКОлаб"  
"КовидЭк Директ"  
Комплект №2

Транспортная среда с муконитом  
100 микропробирок (по 0,5 мл)

Серия: 06

Дата изг.: 2021.07.05

Годен до: 2022.07.05



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики», указаны непосредственно на упаковке.

Руководитель НПО ПЦР

М.С. Войков

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

4 лист 9

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Г.Ю.

2021 г.

