


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Аналитика М»


Вайсман И.Г.
«12» сентября 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Чехол защитный одноразовый для манипулятора роботизированной
хирургической (ортопедической) системы Cuvis-joint»

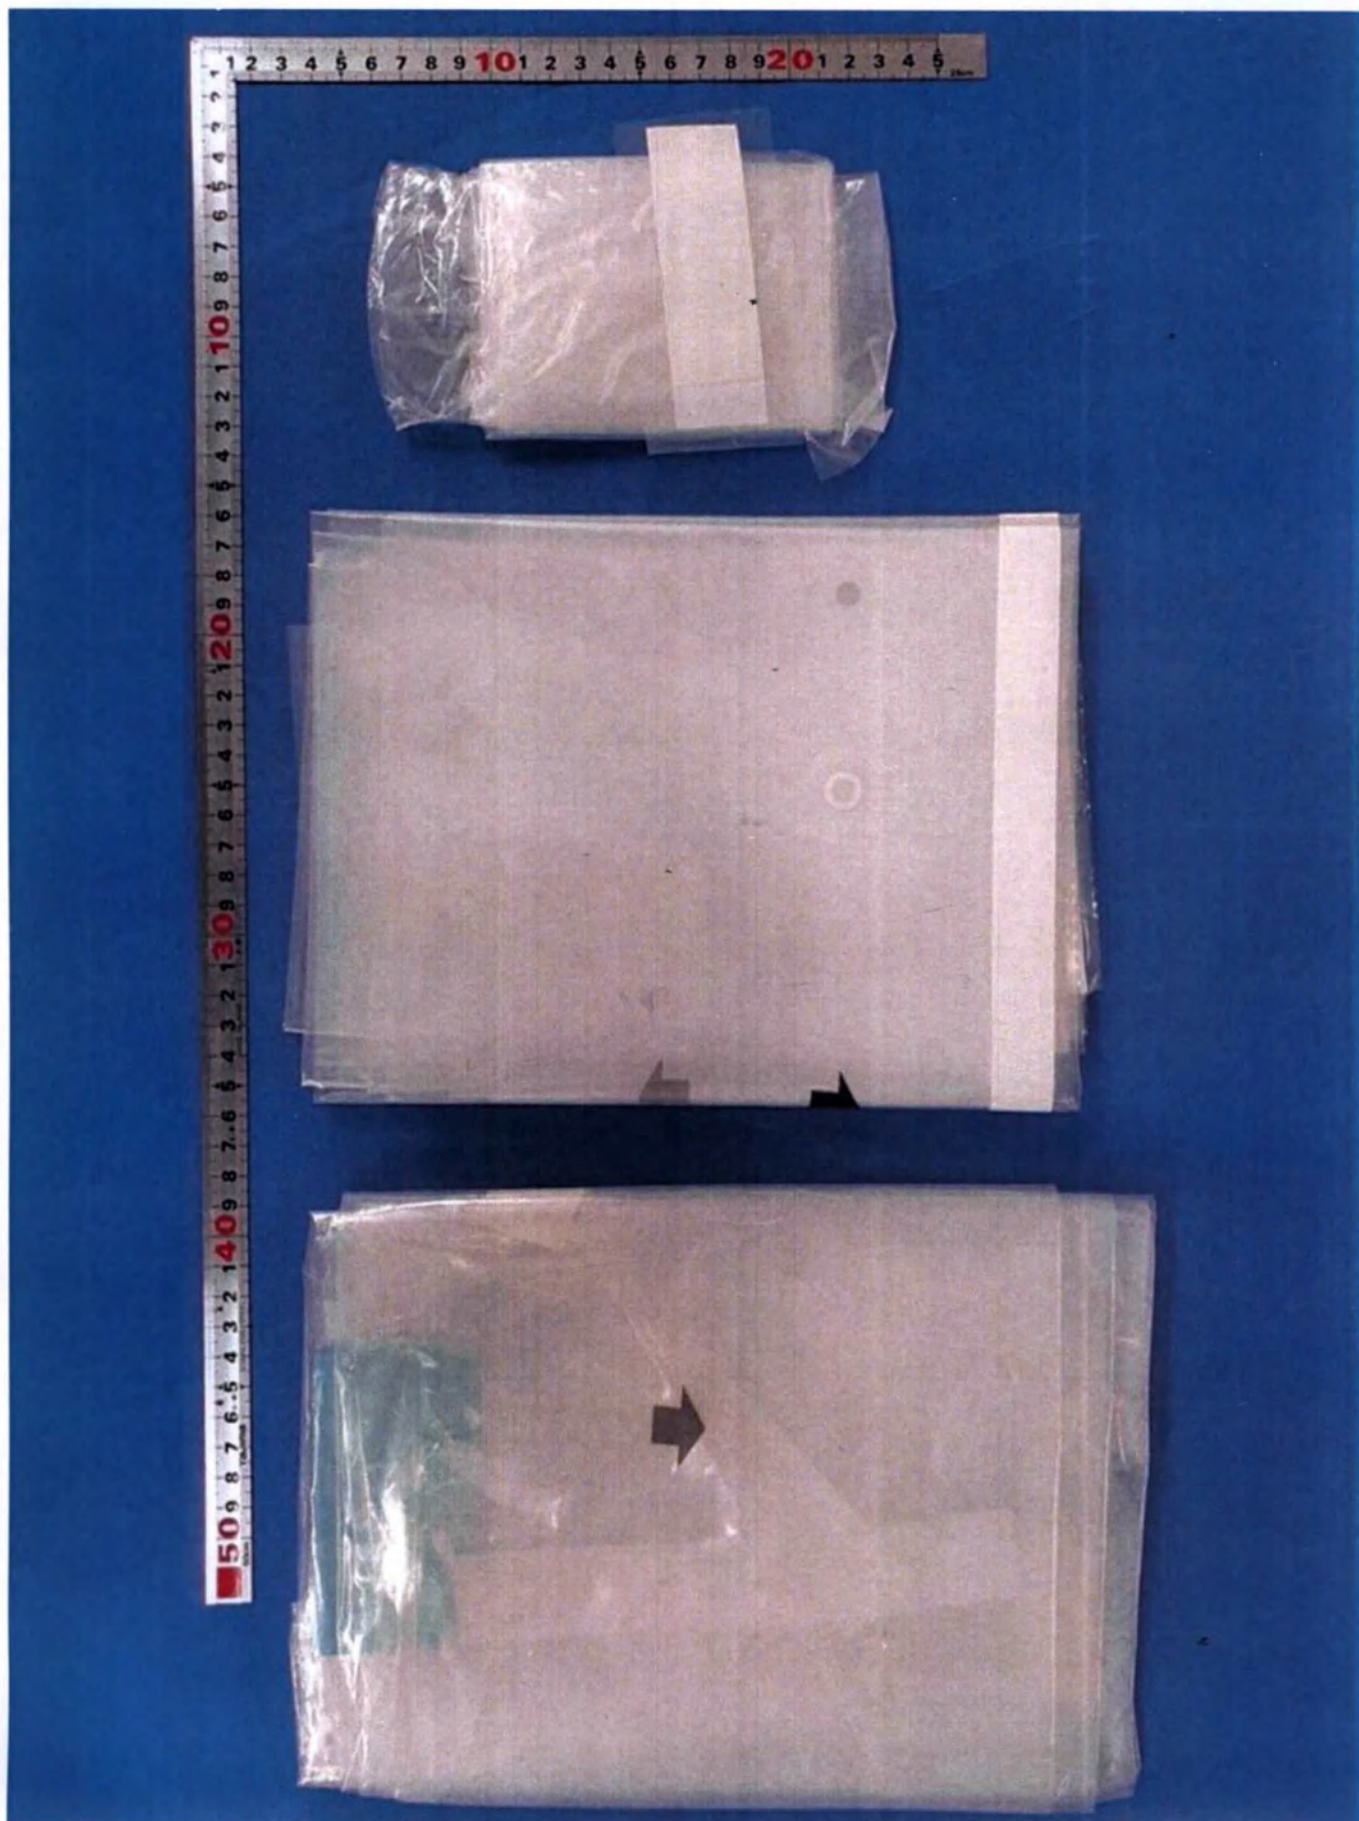


Фото 1 – Общий вид медицинского изделия



Фото 2 – Чехол для манипулятора



Фото 3 – Чехол для манипулятора



Фото 4 – Чехол для опоры



Фото 5 – Чехол для опоры



Фото 6 - Чехол пульта управления



Фото 7 - Чехол пульта управления

CUVIS
JOINT RBC PACK

RBC-002

1	RBC-006-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-007-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-008-C	CUVIS JOINT RBC

인회용 표준공품

02 **DOWOO®**

사용방법

- 1 포장지 개봉 전 파손된 부분이 없는지 확인한다.
- 2 포장지 개봉 후 제품의 손상여부를 확인한다. 특히 봉제부분이 있는 경우, 마검치라이에 이상이 없는지 확인한다.
- 3 본 제품은 **인회용이므로 재검공 및 재사용을 금하며**, 사용 후 폐기를 처리법에 따라 처리한다.

사용시 주의사항

- 1 화상 및 화학제에 접촉을 피하여 인회용 물량이 있는 곳에서 사용을 위하여 주십시오.
- 2 포장이 파손되었거나 유효기간이 지난 것은 절대 사용하지 마십시오.
- 3 시술자는 취급조작을 중립히 숙지하고서 사용하십시오.

제조사(인회): 인회용 표준공품(포장에 기재)
 제조업 허가번호: F.L 제 3533호
 보관 또는 저장방법: 직사광선을 피하고 상온에 보관
 LOT No./제조일자: 포장에 기재
 사용기간: 제조일로부터 3년까지

포장단위: Pack 유효기간: 제조일로부터 3년

STERILE EO

본제품은 의료기기이며

제조자1 / (주)인회용 표준공품 144 제조자2 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품 395면 144 제조자1 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품 395면 144 제조자1 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품

02 **DOWOO®**

CUVIS
JOINT RBC PACK

RBC-002

1	RBC-006-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-007-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-008-C	CUVIS JOINT RBC

사용방법

- 1 포장지 개봉 전 파손된 부분이 없는지 확인한다.
- 2 포장지 개봉 후 제품의 손상여부를 확인한다. 특히 봉제부분이 있는 경우, 마검치라이에 이상이 없는지 확인한다.
- 3 본 제품은 **인회용이므로 재검공 및 재사용을 금하며**, 사용 후 폐기를 처리법에 따라 처리한다.

사용시 주의사항

- 1 화상 및 화학제에 접촉을 피하여 인회용 물량이 있는 곳에서 사용을 위하여 주십시오.
- 2 포장이 파손되었거나 유효기간이 지난 것은 절대 사용하지 마십시오.
- 3 시술자는 취급조작을 중립히 숙지하고서 사용하십시오.

제조사(인회): 인회용 표준공품(포장에 기재)
 제조업 허가번호: F.L 제 3533호
 보관 또는 저장방법: 직사광선을 피하고 상온에 보관
 LOT No./제조일자: 포장에 기재
 사용기간: 제조일로부터 3년까지

포장단위: Pack 유효기간: 제조일로부터 3년

STERILE EO

본제품은 의료기기이며

제조자1 / (주)인회용 표준공품 144 제조자2 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품 395면 144 제조자1 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품 395면 144 제조자1 / (주)인회용 표준공품 31.51

인회용 표준공품

02 **DOWOO®**

CUVIS
JOINT RBC PACK

RBC-002

1	RBC-006-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-007-C	CUVIS JOINT RBC
1	RBC-008-C	CUVIS JOINT RBC



Фото 9 – Упаковка медицинского изделия

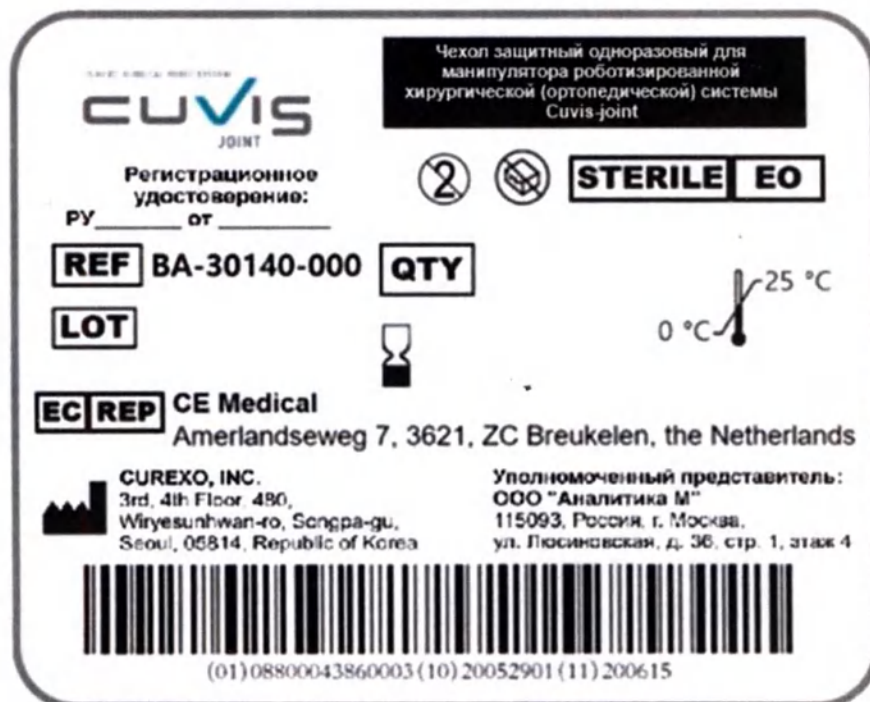


Фото 10 – Русскоязычная маркировка медицинского изделия

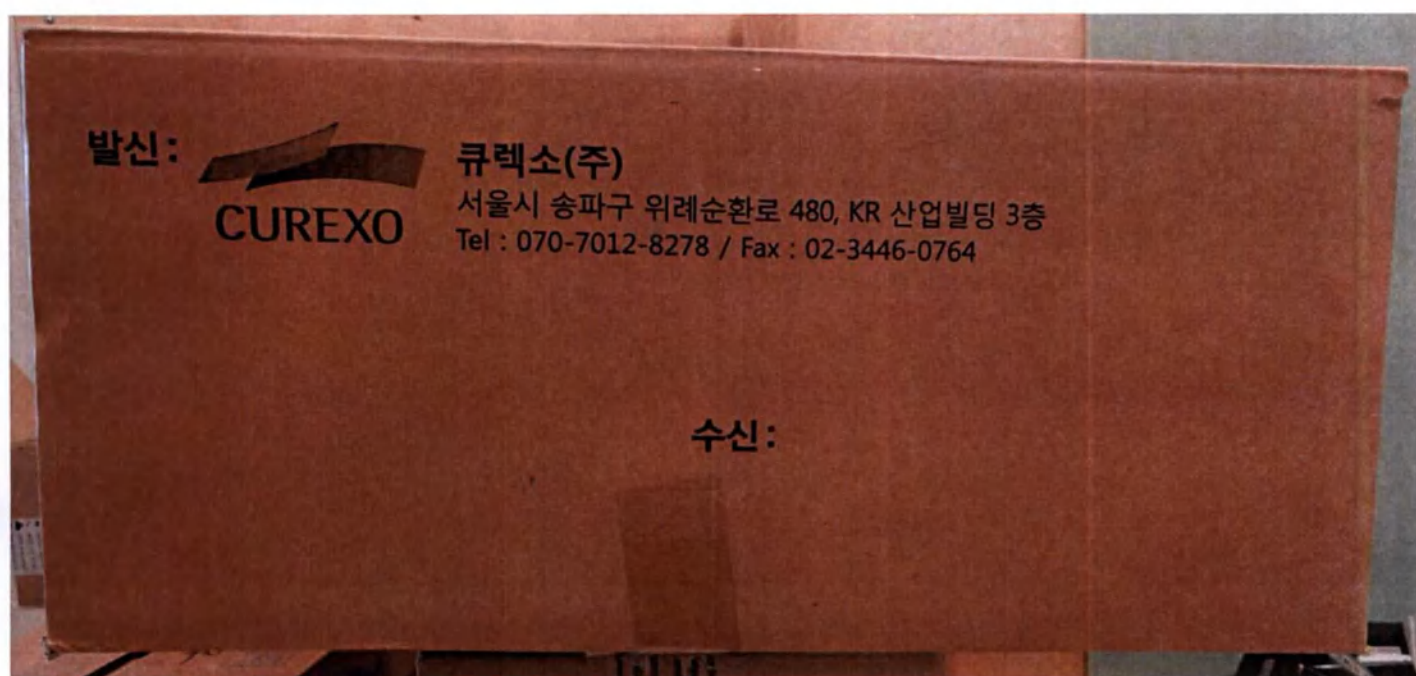




Фото 11 – Транспортная упаковка

11

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

12 л.

Генеральный директор
Вайсман И.Г.

