

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Аналитика М»

Вайсман И.Г.

«__» _____ 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Инструменты основные одноразовые для роботизированной хирургической
(ортопедической) системы CUVIS-joint, модель CJ150»

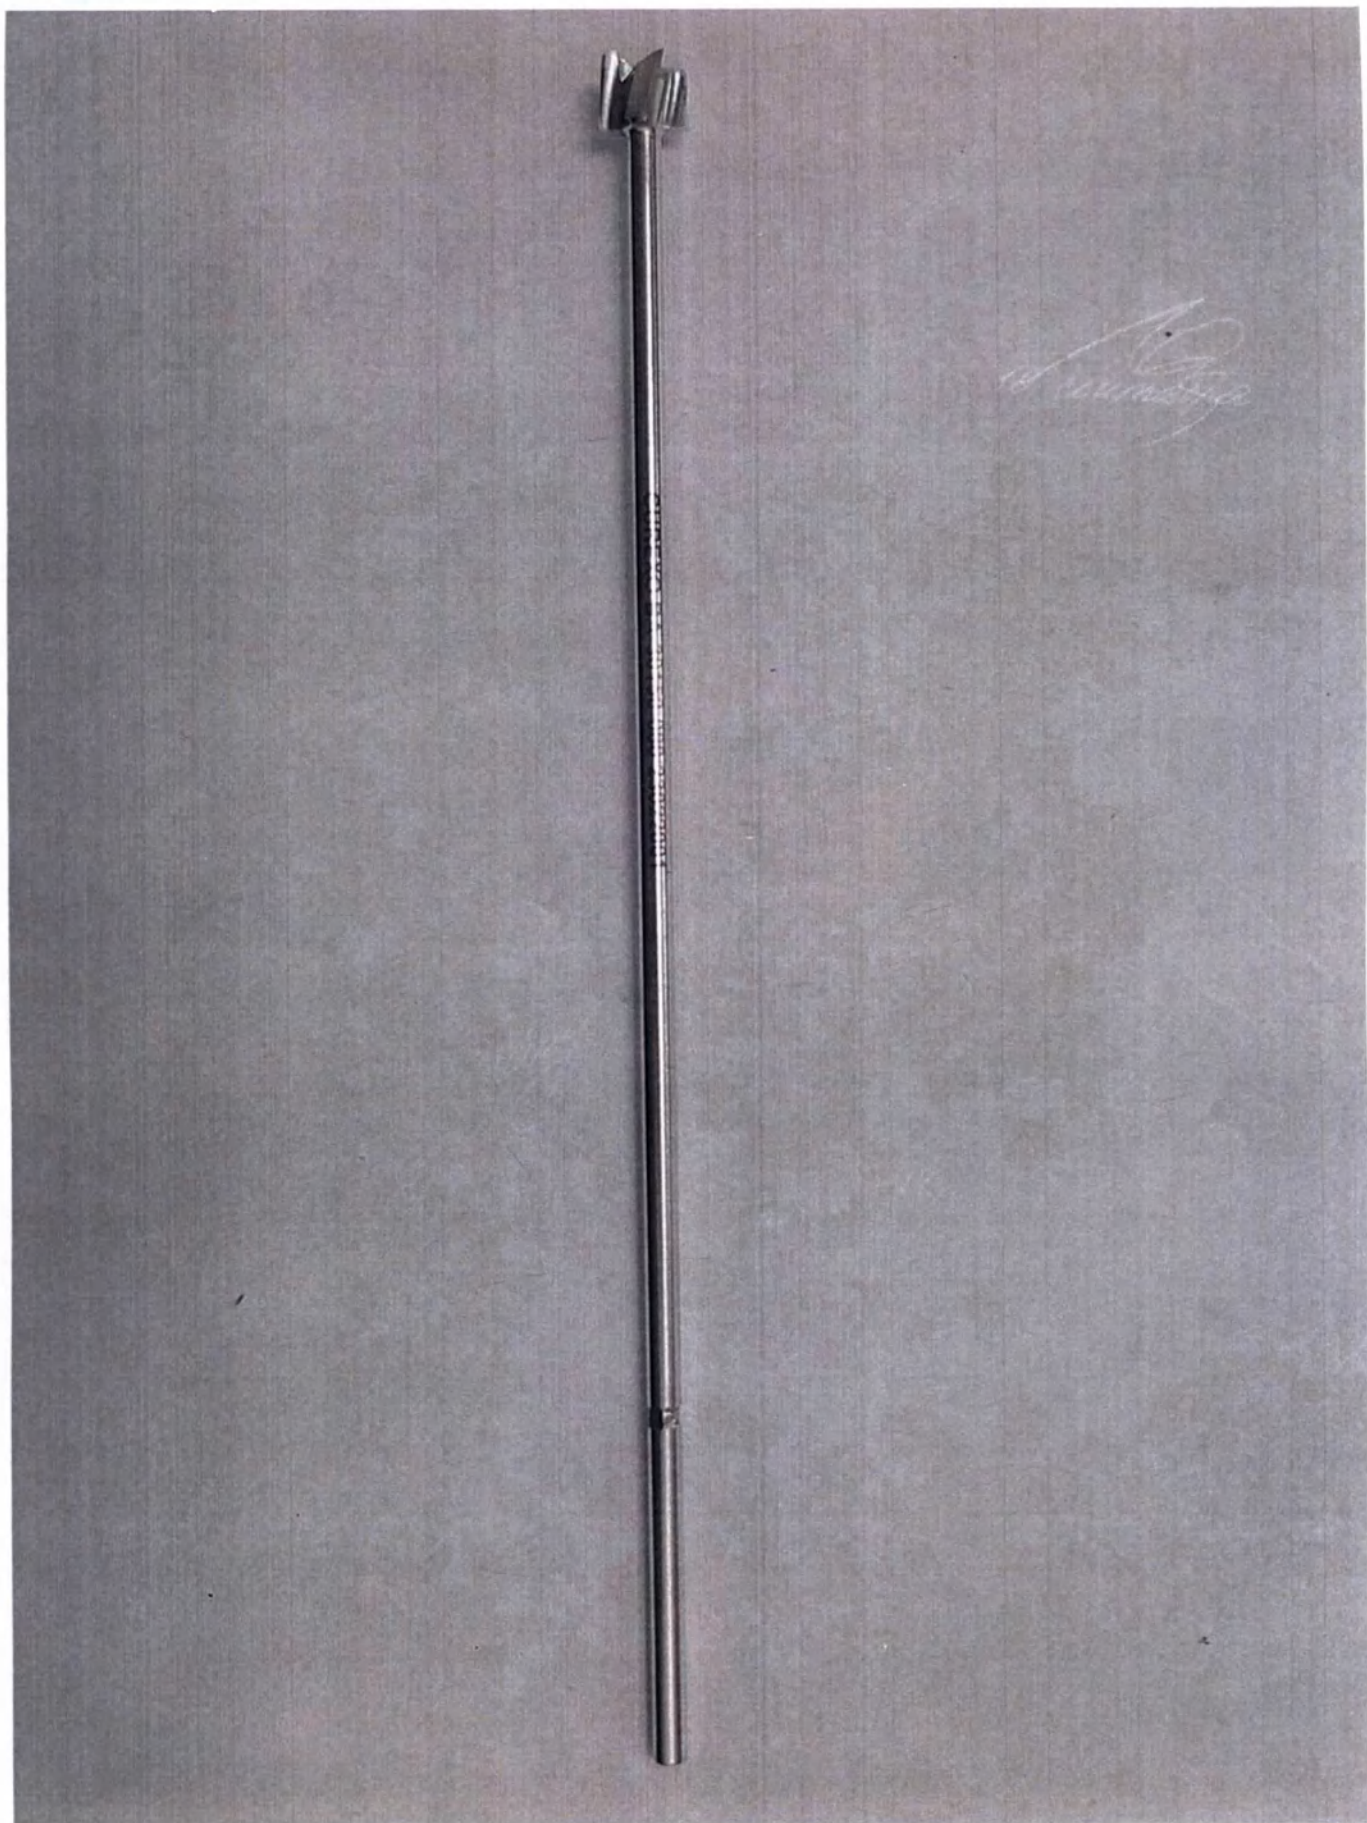


Фото 1 - Фреза 6,2 мм ВА-30150-000

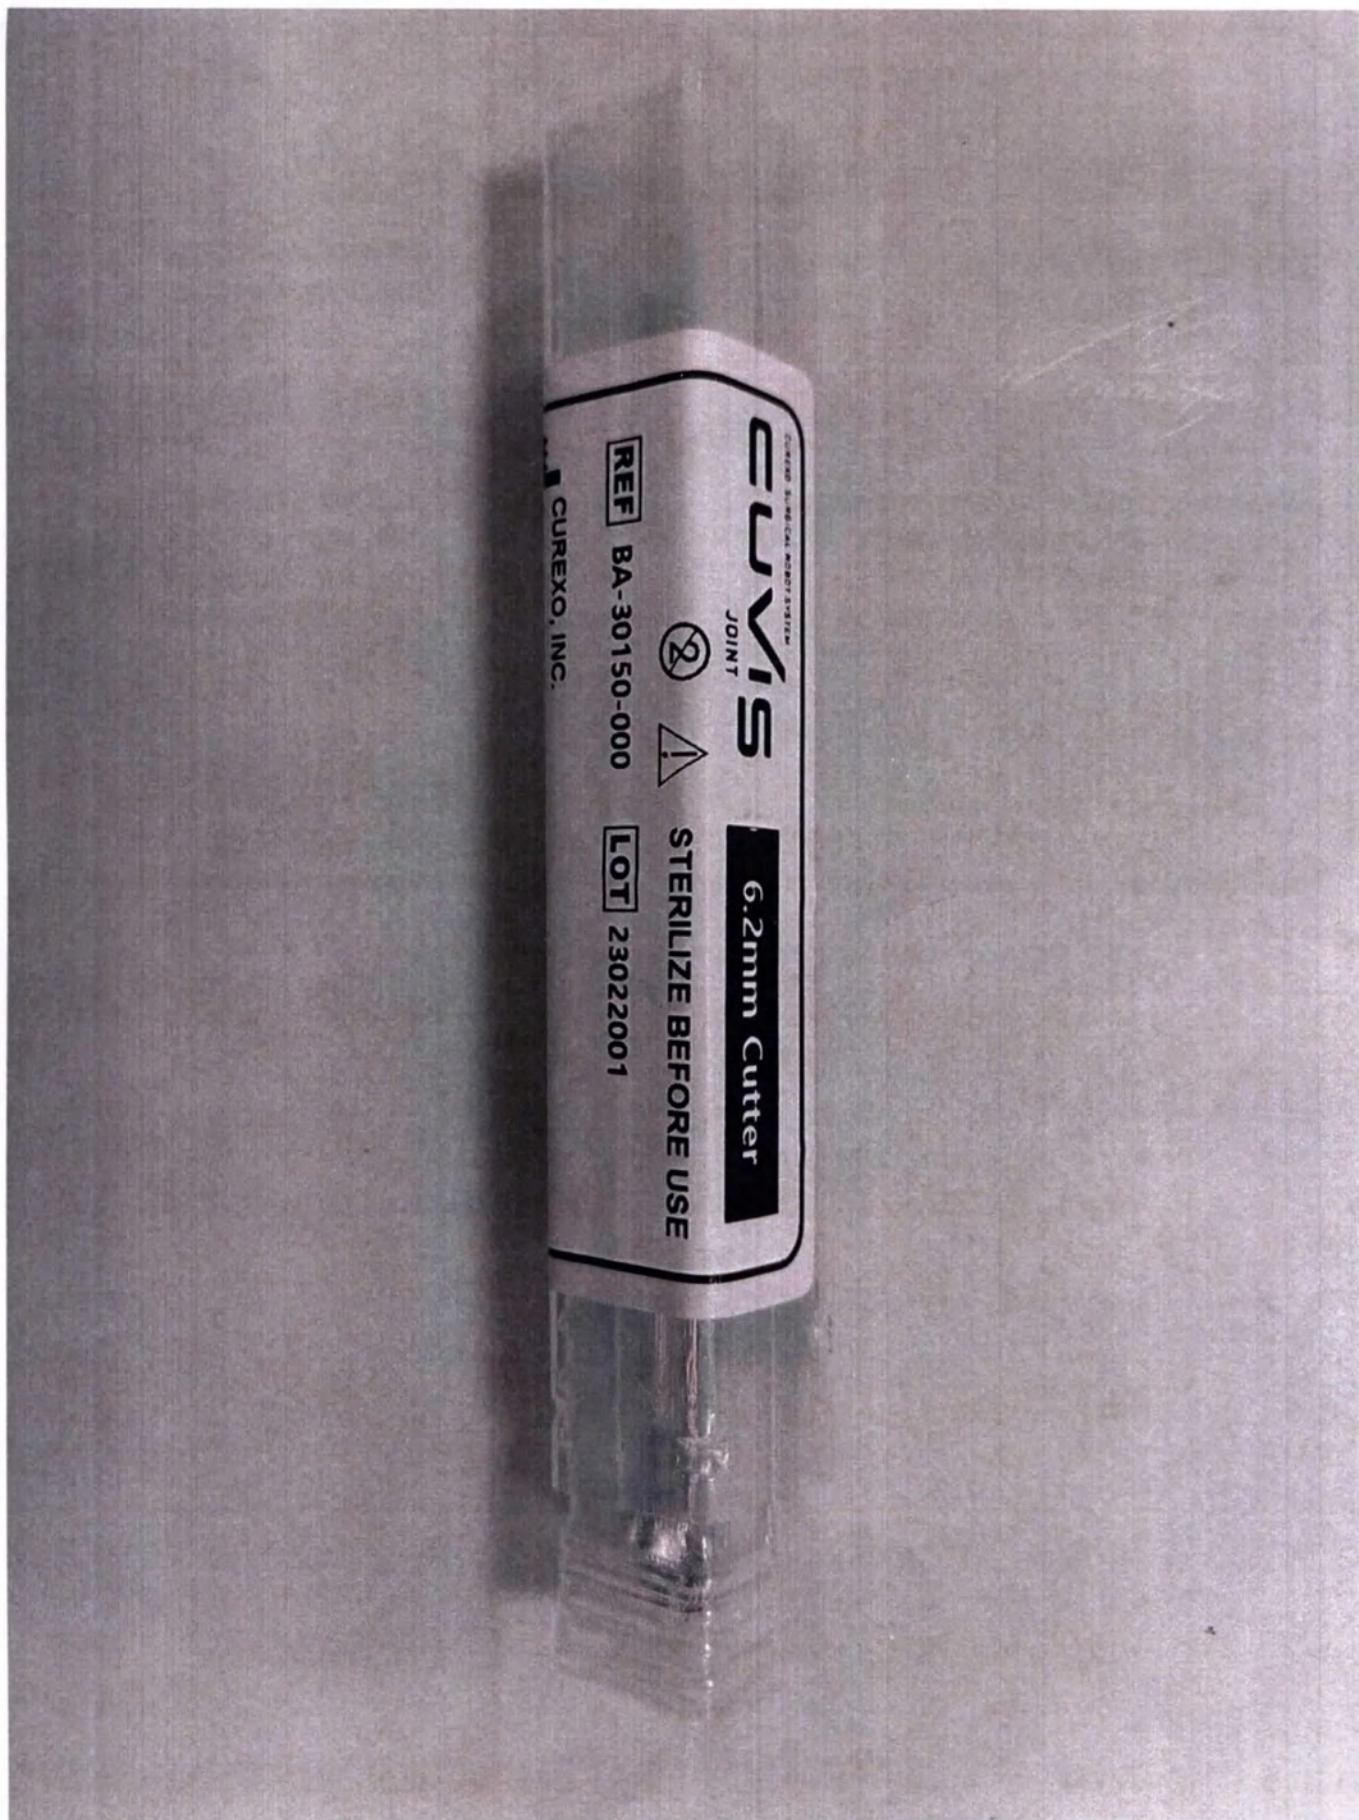


Фото 2 – Упаковка Фрезы 6,2 мм BA-30150-000

CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

3.2mm фреза

Регистрационное
удостоверение:
ру _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-30150-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryehsunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 3 – Русскоязычная маркировка Фрезы 6,2 мм BA-30150-000



Фото 4 - Фреза прямая 6,2 мм ВА-31800-000

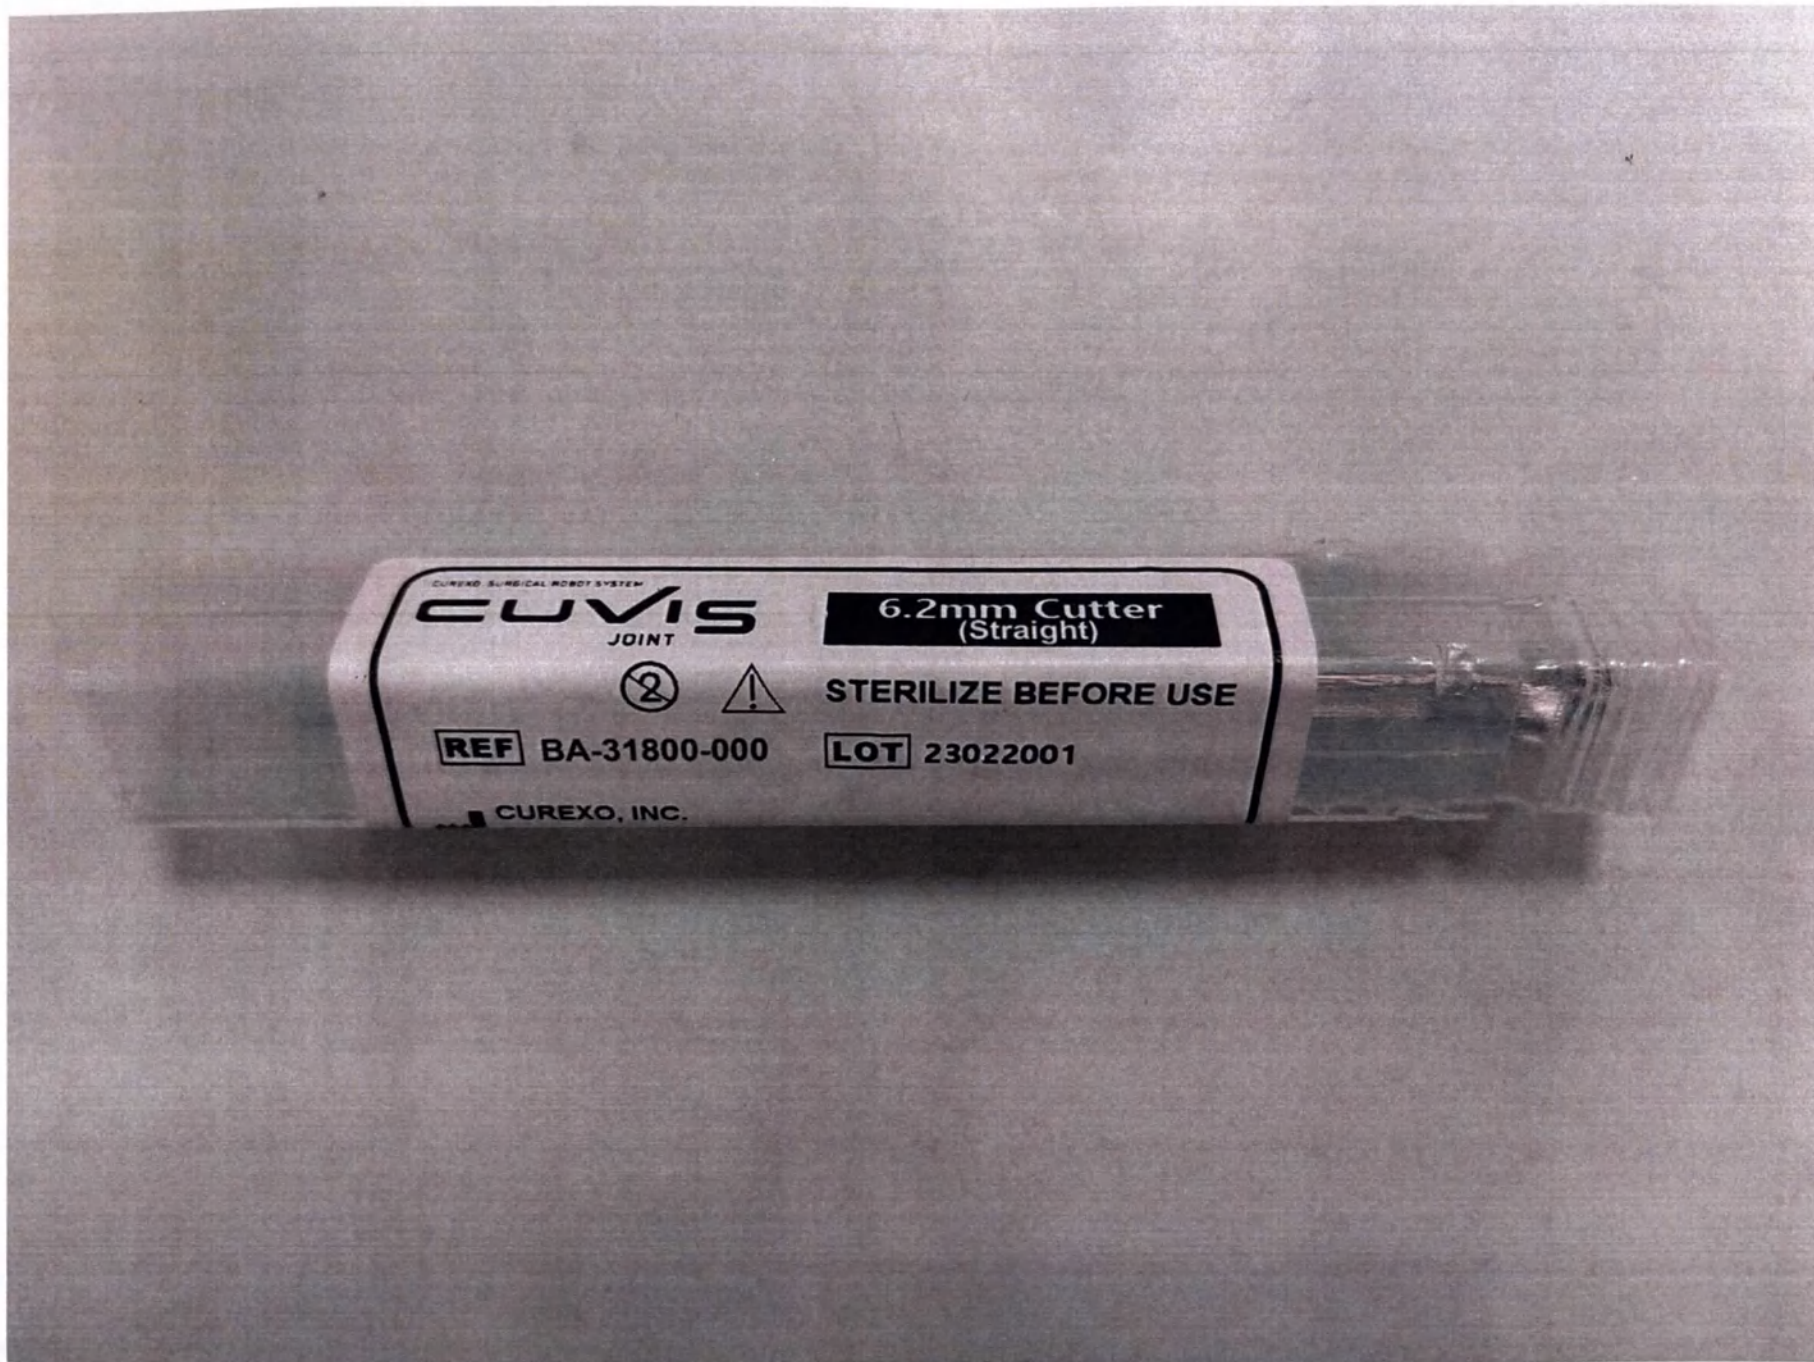


Фото 5 – Упаковка Фрезы прямой 6,2 мм BA-31800-000


CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

6.2 мм Фреза (прямая)

Регистрационное
удостоверение:

ру _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF **BA-31800-000**

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryesunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 6 – Русскоязычная маркировка Фрезы прямой 6,2 мм BA-31800-000



Фото 7 - Фреза 5,0 мм BA-31700-000

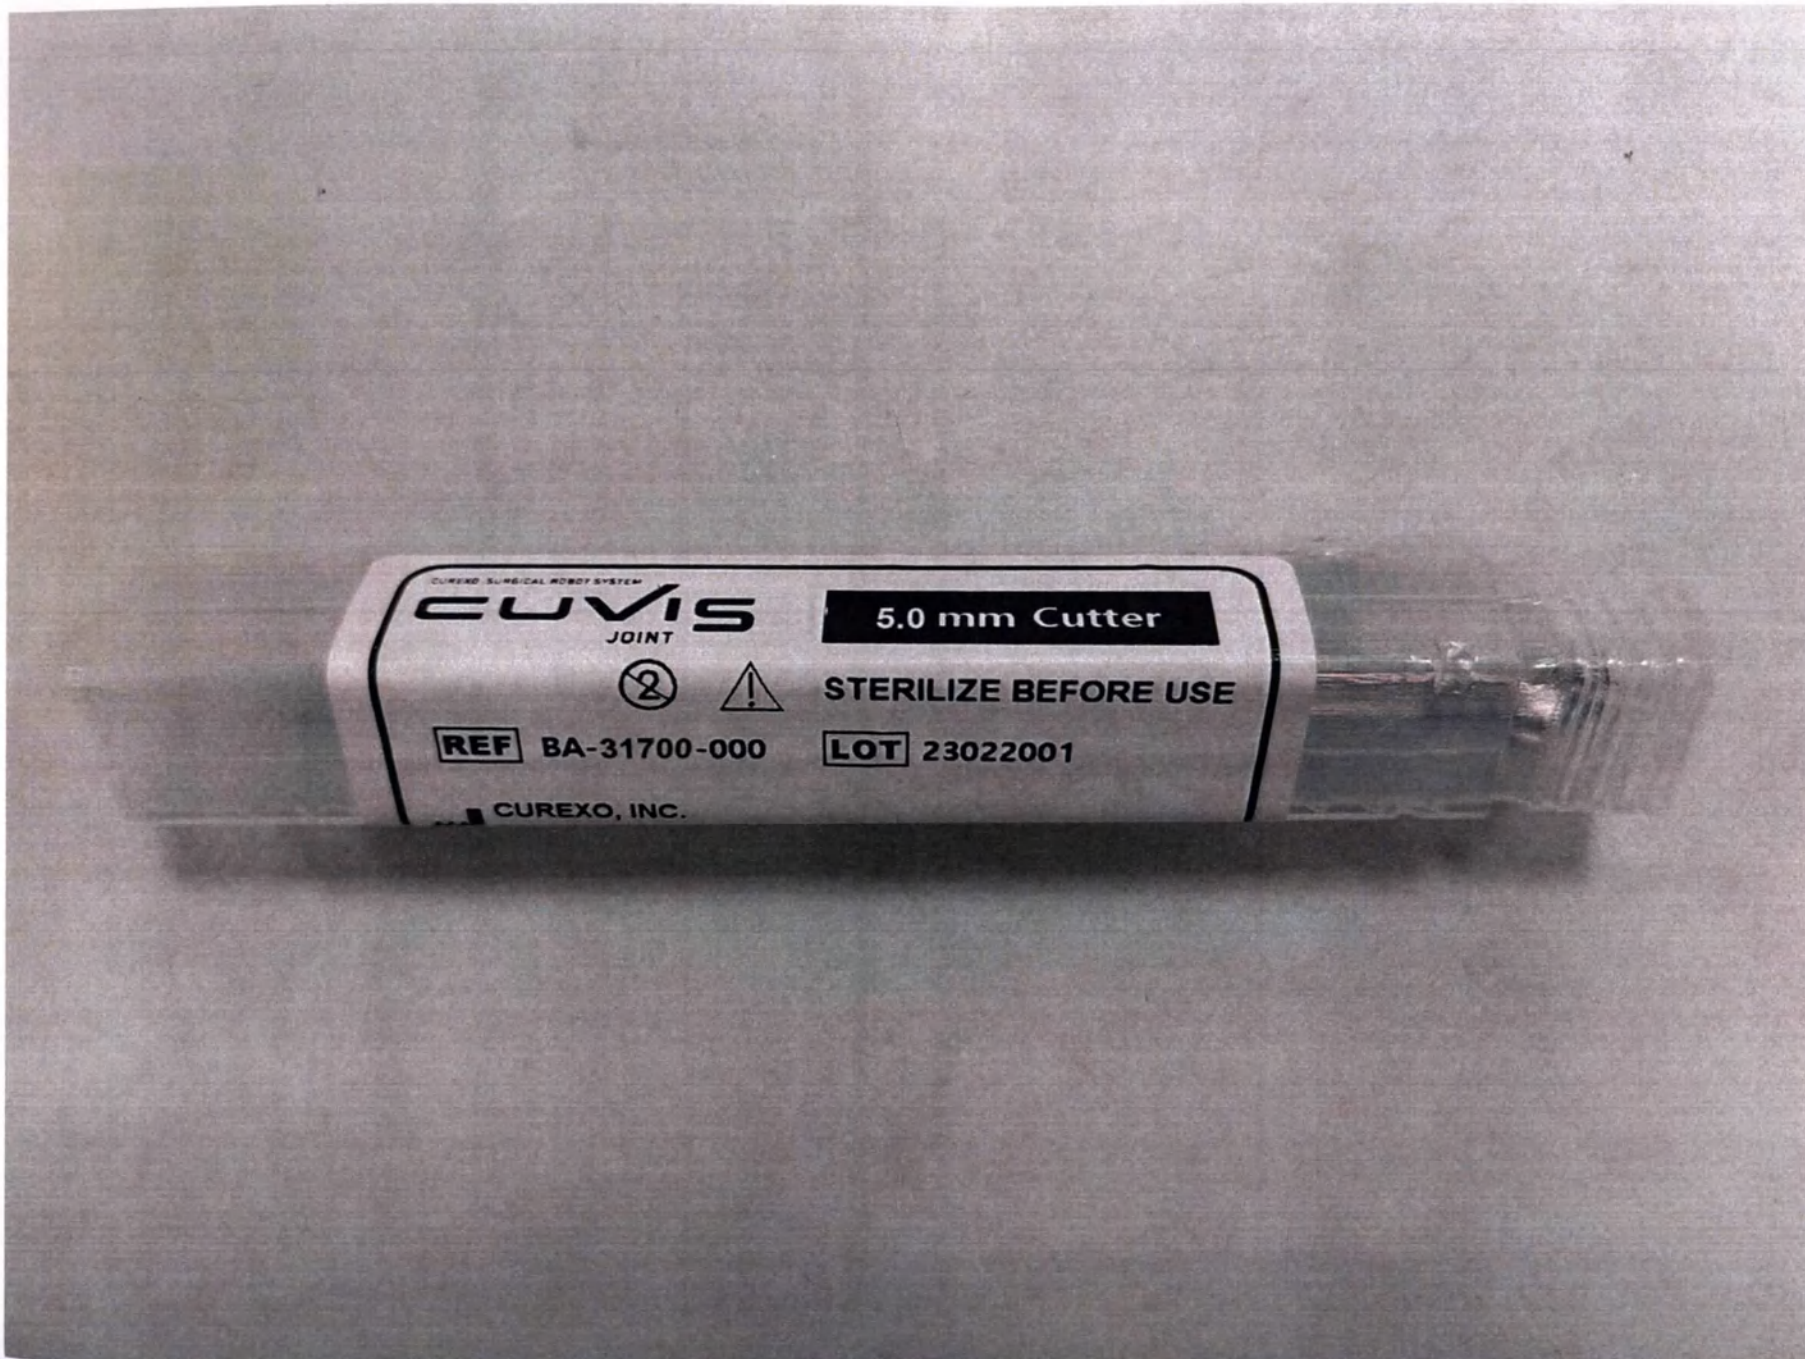


Фото 8 – Упаковка Фрезы 5,0 мм BA-31700-000


CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

5.0mm фреза

Регистрационное
удостоверение:

РУ _____ ОТ _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-31700-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryehunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 9 – Русскоязычная маркировка Фрезы 5,0 мм BA-31700-000



Фото 10 - Фреза 3,2 мм BA-31900-000



Фото 11 – Упаковка Фрезы 3,2 мм BA-31900-000

CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

3.2mm фреза

Регистрационное
удостоверение:
ру _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-31900-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryehunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 12 – Русскоязычная маркировка Фрезы 3,2 мм ВА-31900-000

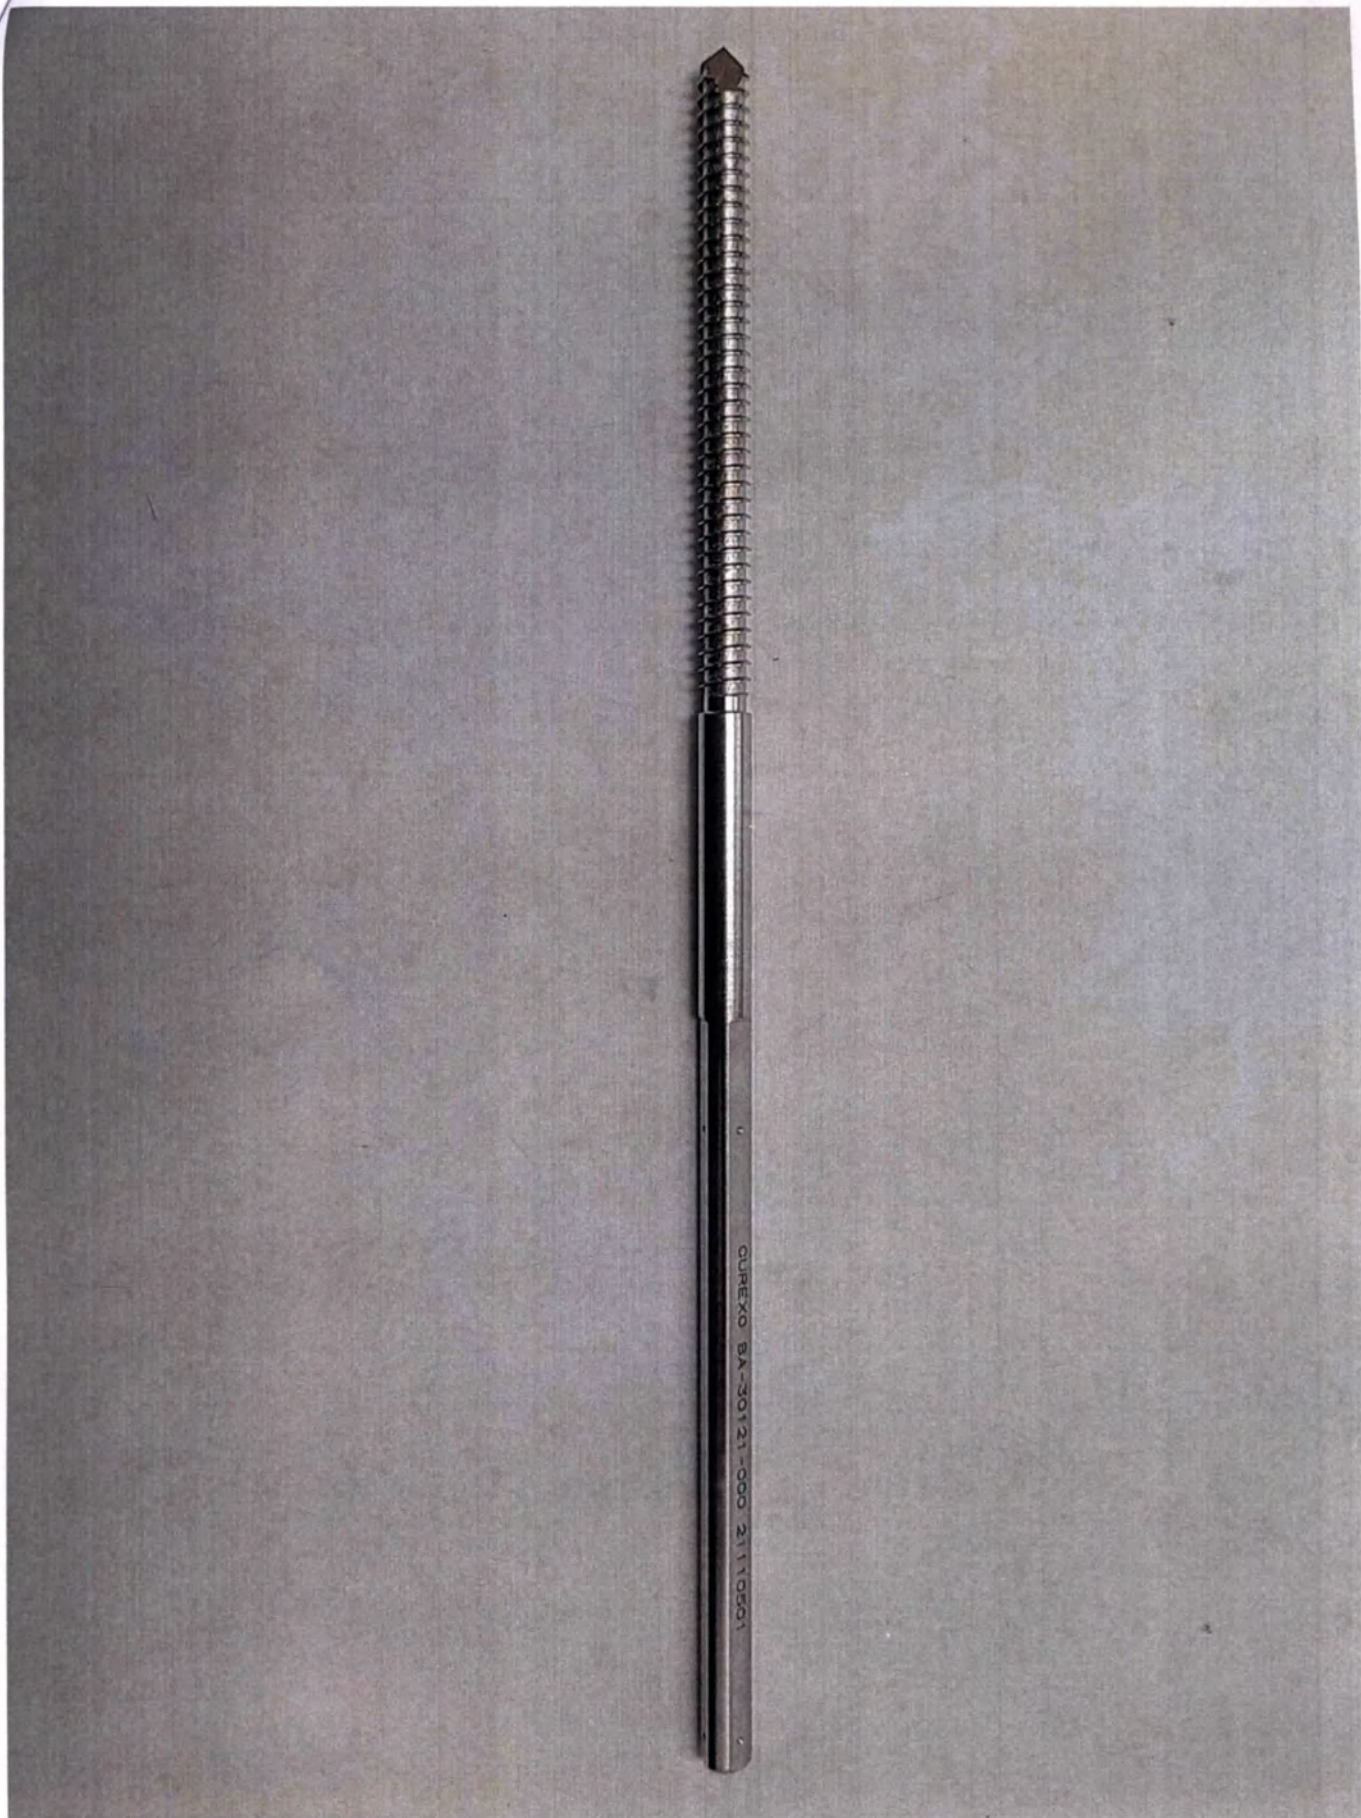


Фото 13 - Винт Шанца Ø5, 160 мм ВА-30121-000

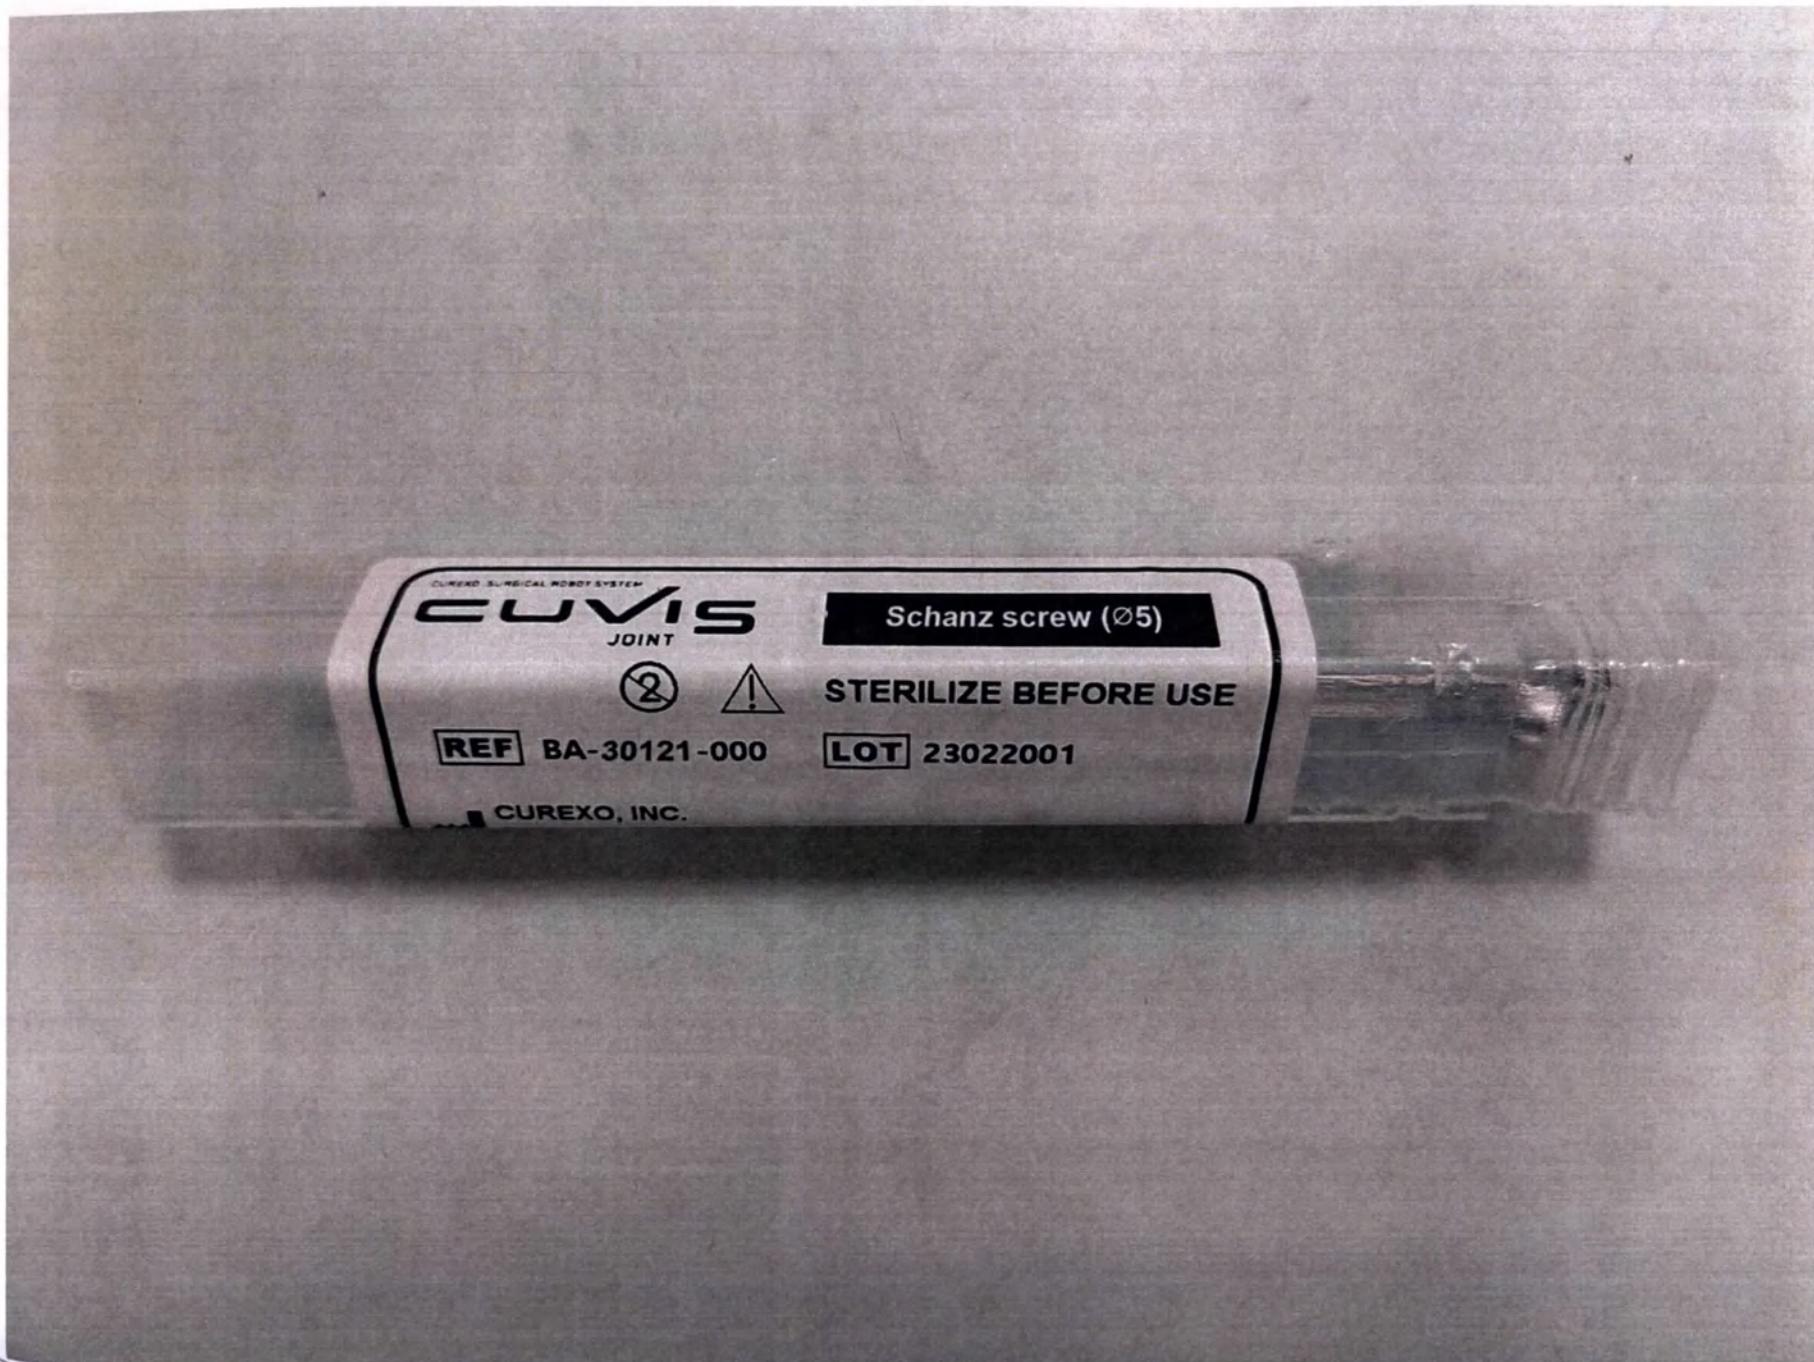


Фото 14 – Упаковка Винта Шанца Ø5, 160 мм BA-30121-000


CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

Винт Шанца Ø5, 160 мм

Регистрационное
удостоверение:

РУ _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-30121-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryeseunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 15 – Русскоязычная маркировка Винта Шанца Ø5, 160 мм BA-30121-000

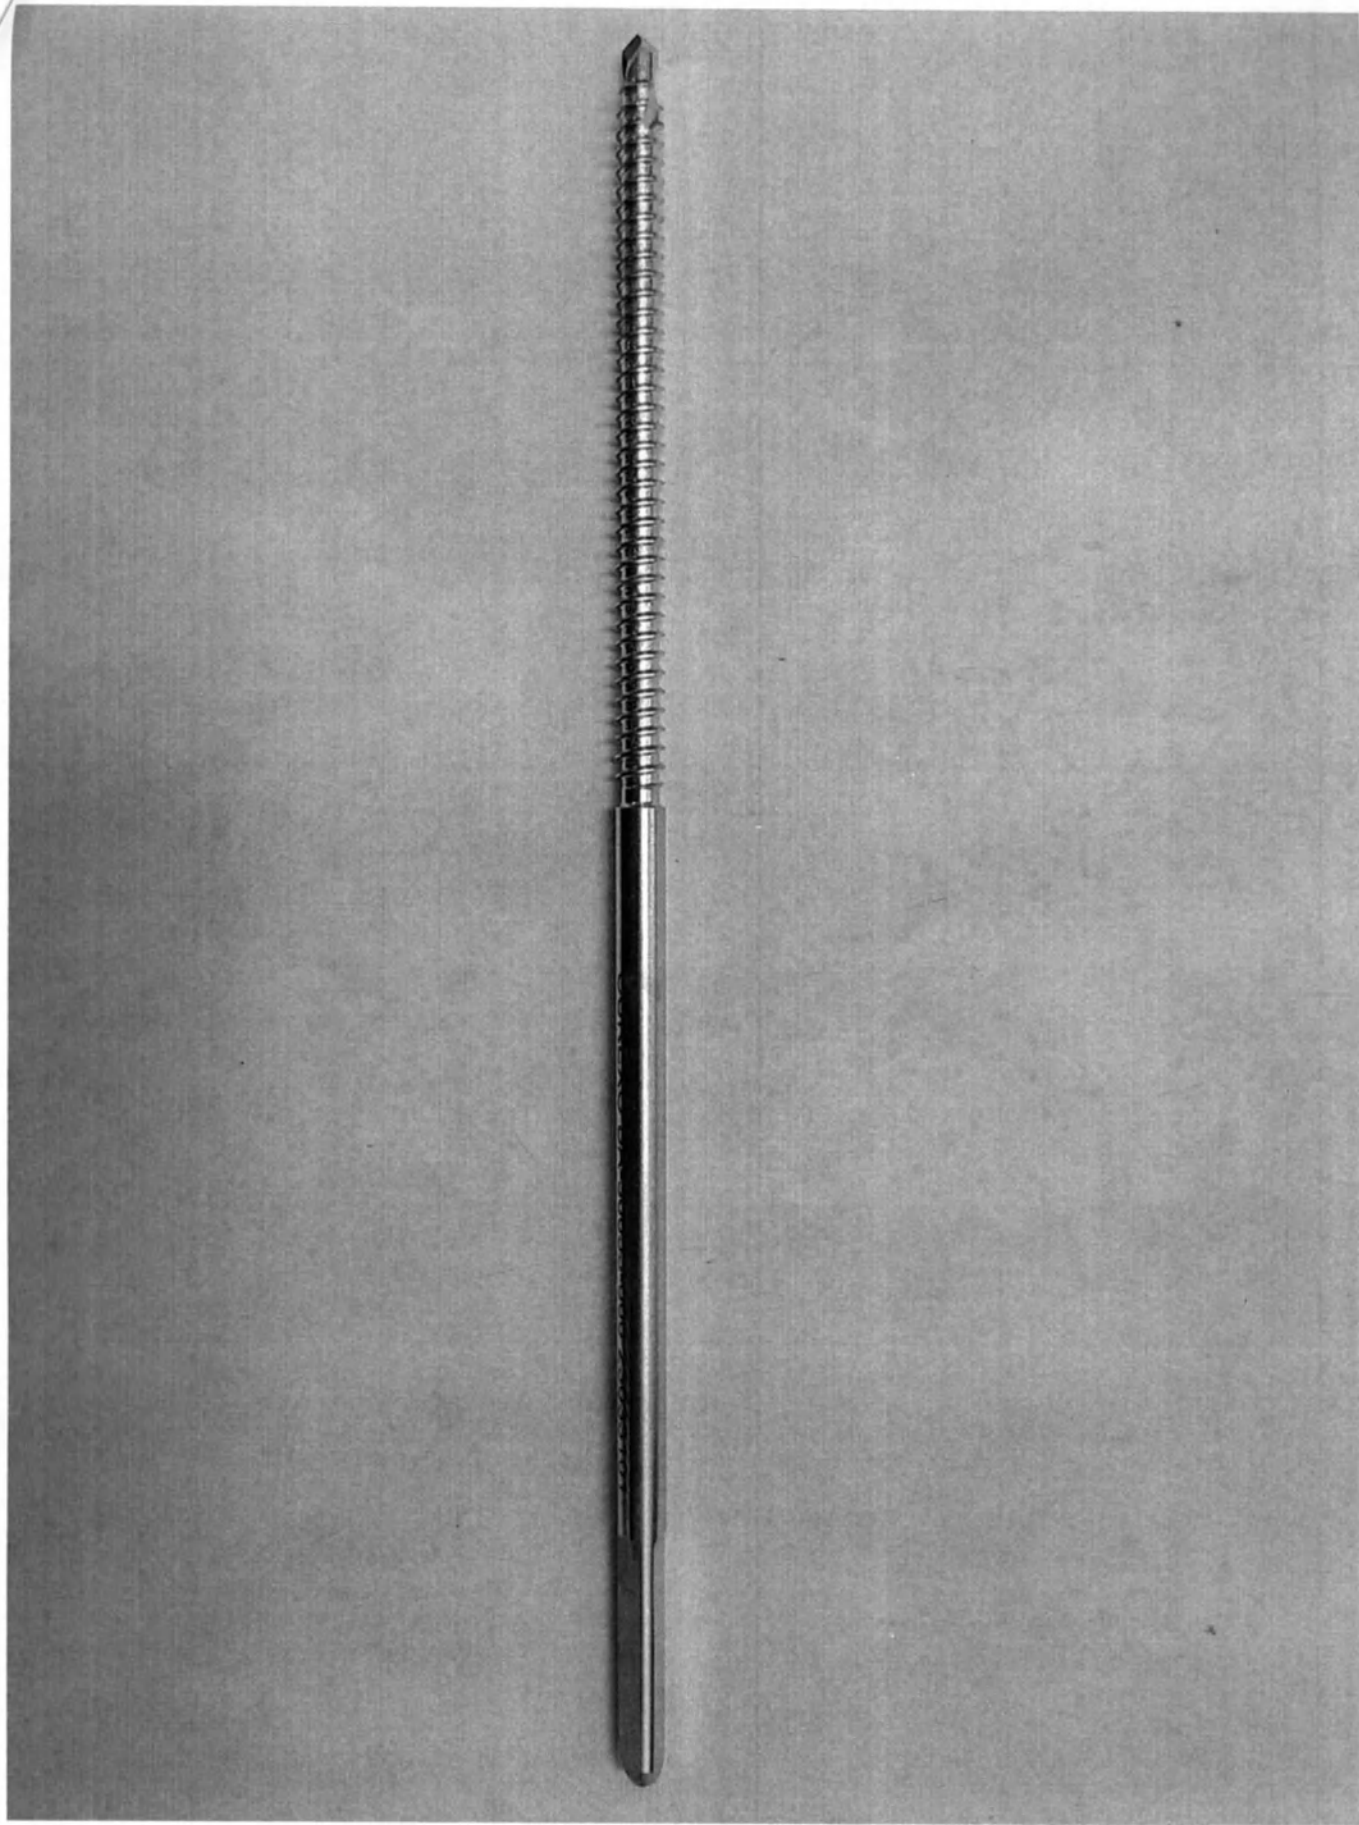


Фото 16 - Винт Шанца Ø4, 140 мм ВА-30053-000




Фото 17 – Упаковка Винта Шанца Ø4, 140 мм BA-30053-000

CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

Винт Шанца Ø4, 140 мм

Регистрационное
удостоверение:
ру _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-30053-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryesunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 18 – Русскоязычная маркировка Винта Шанца Ø4, 140 мм BA-30053-000

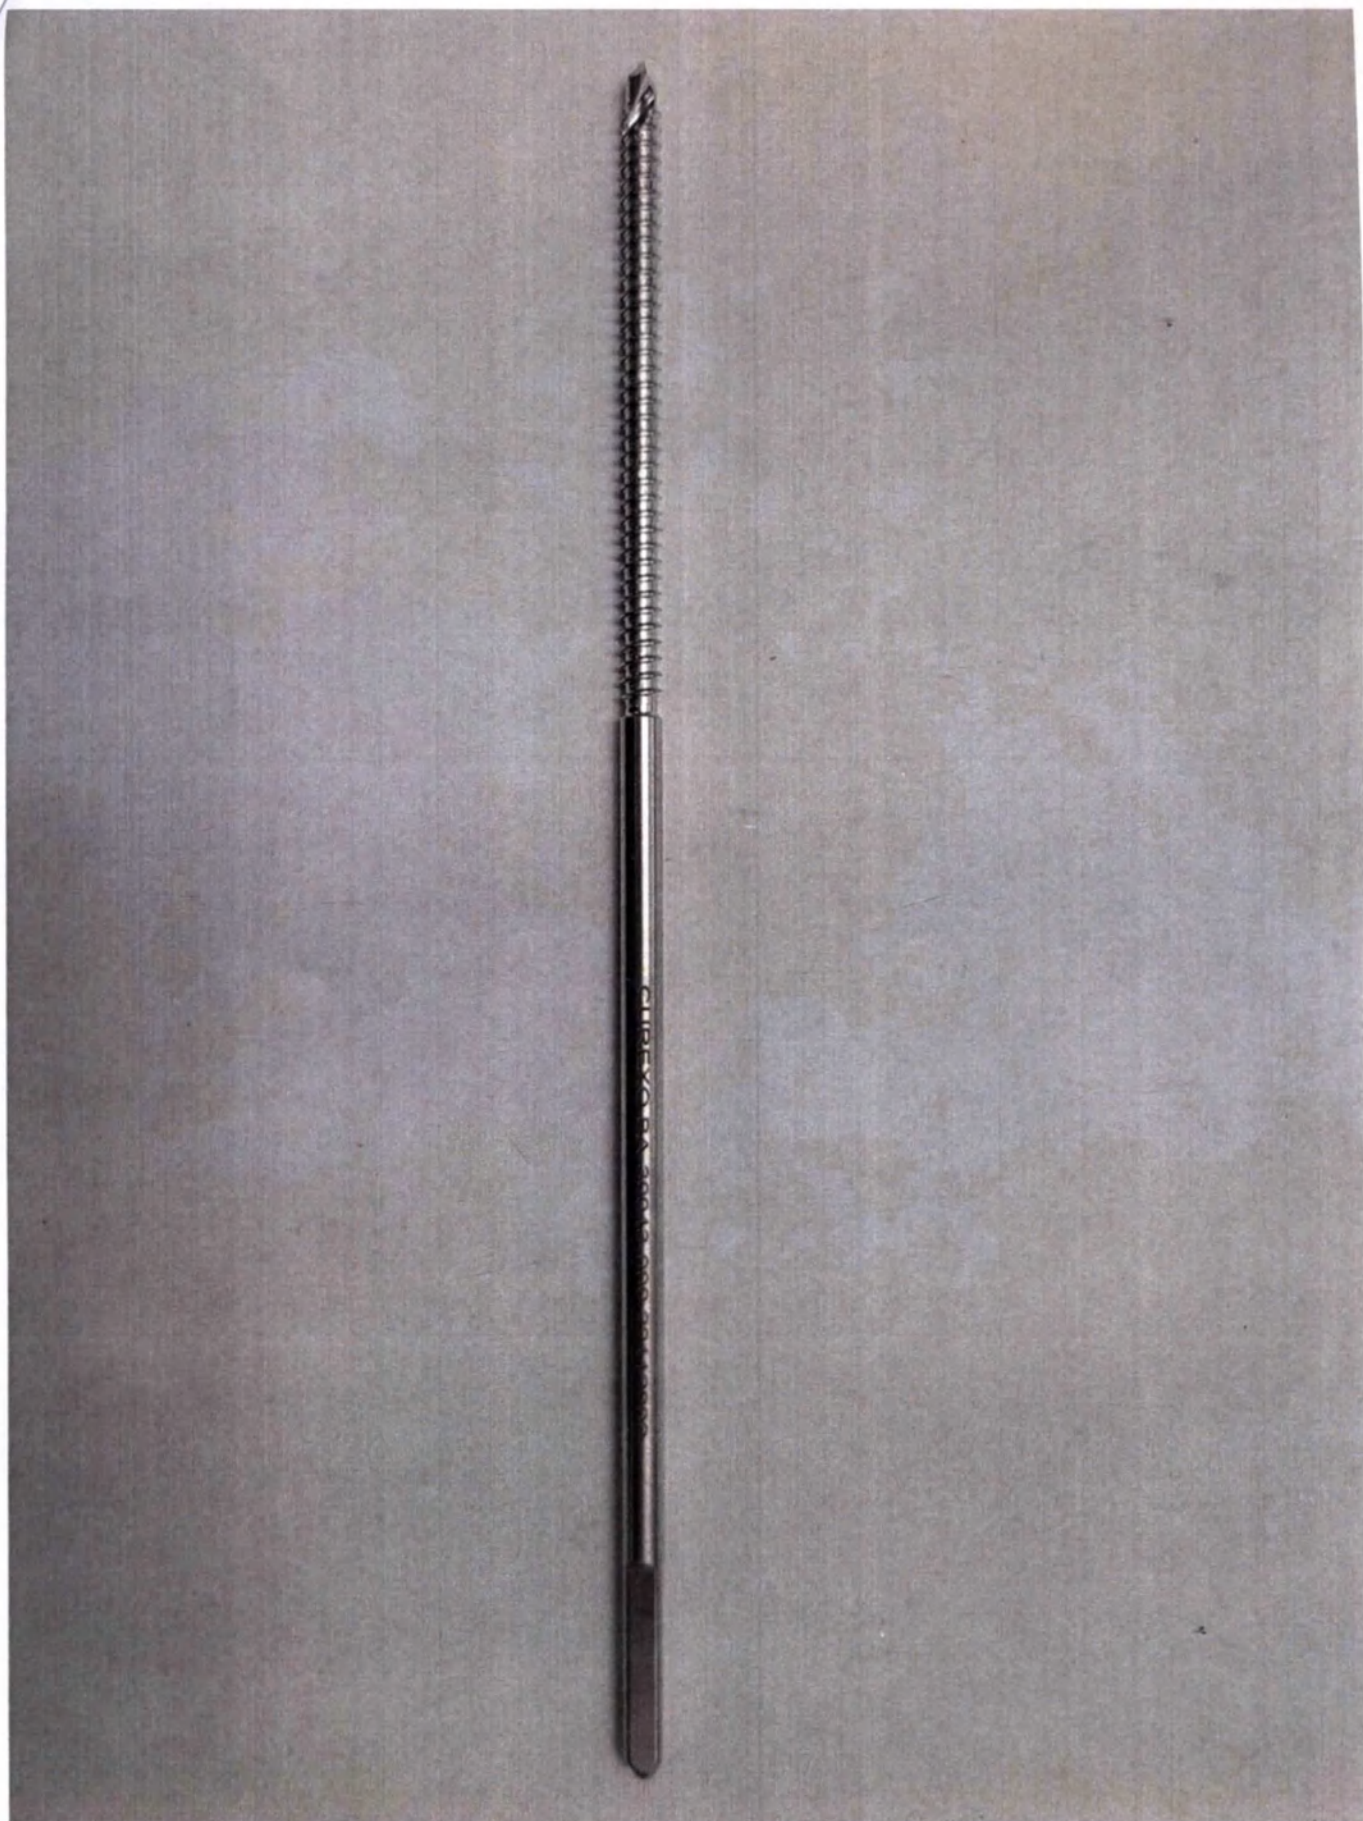


Фото 19 - Винт Шанца Ø4, 160 мм ВА-30043-000

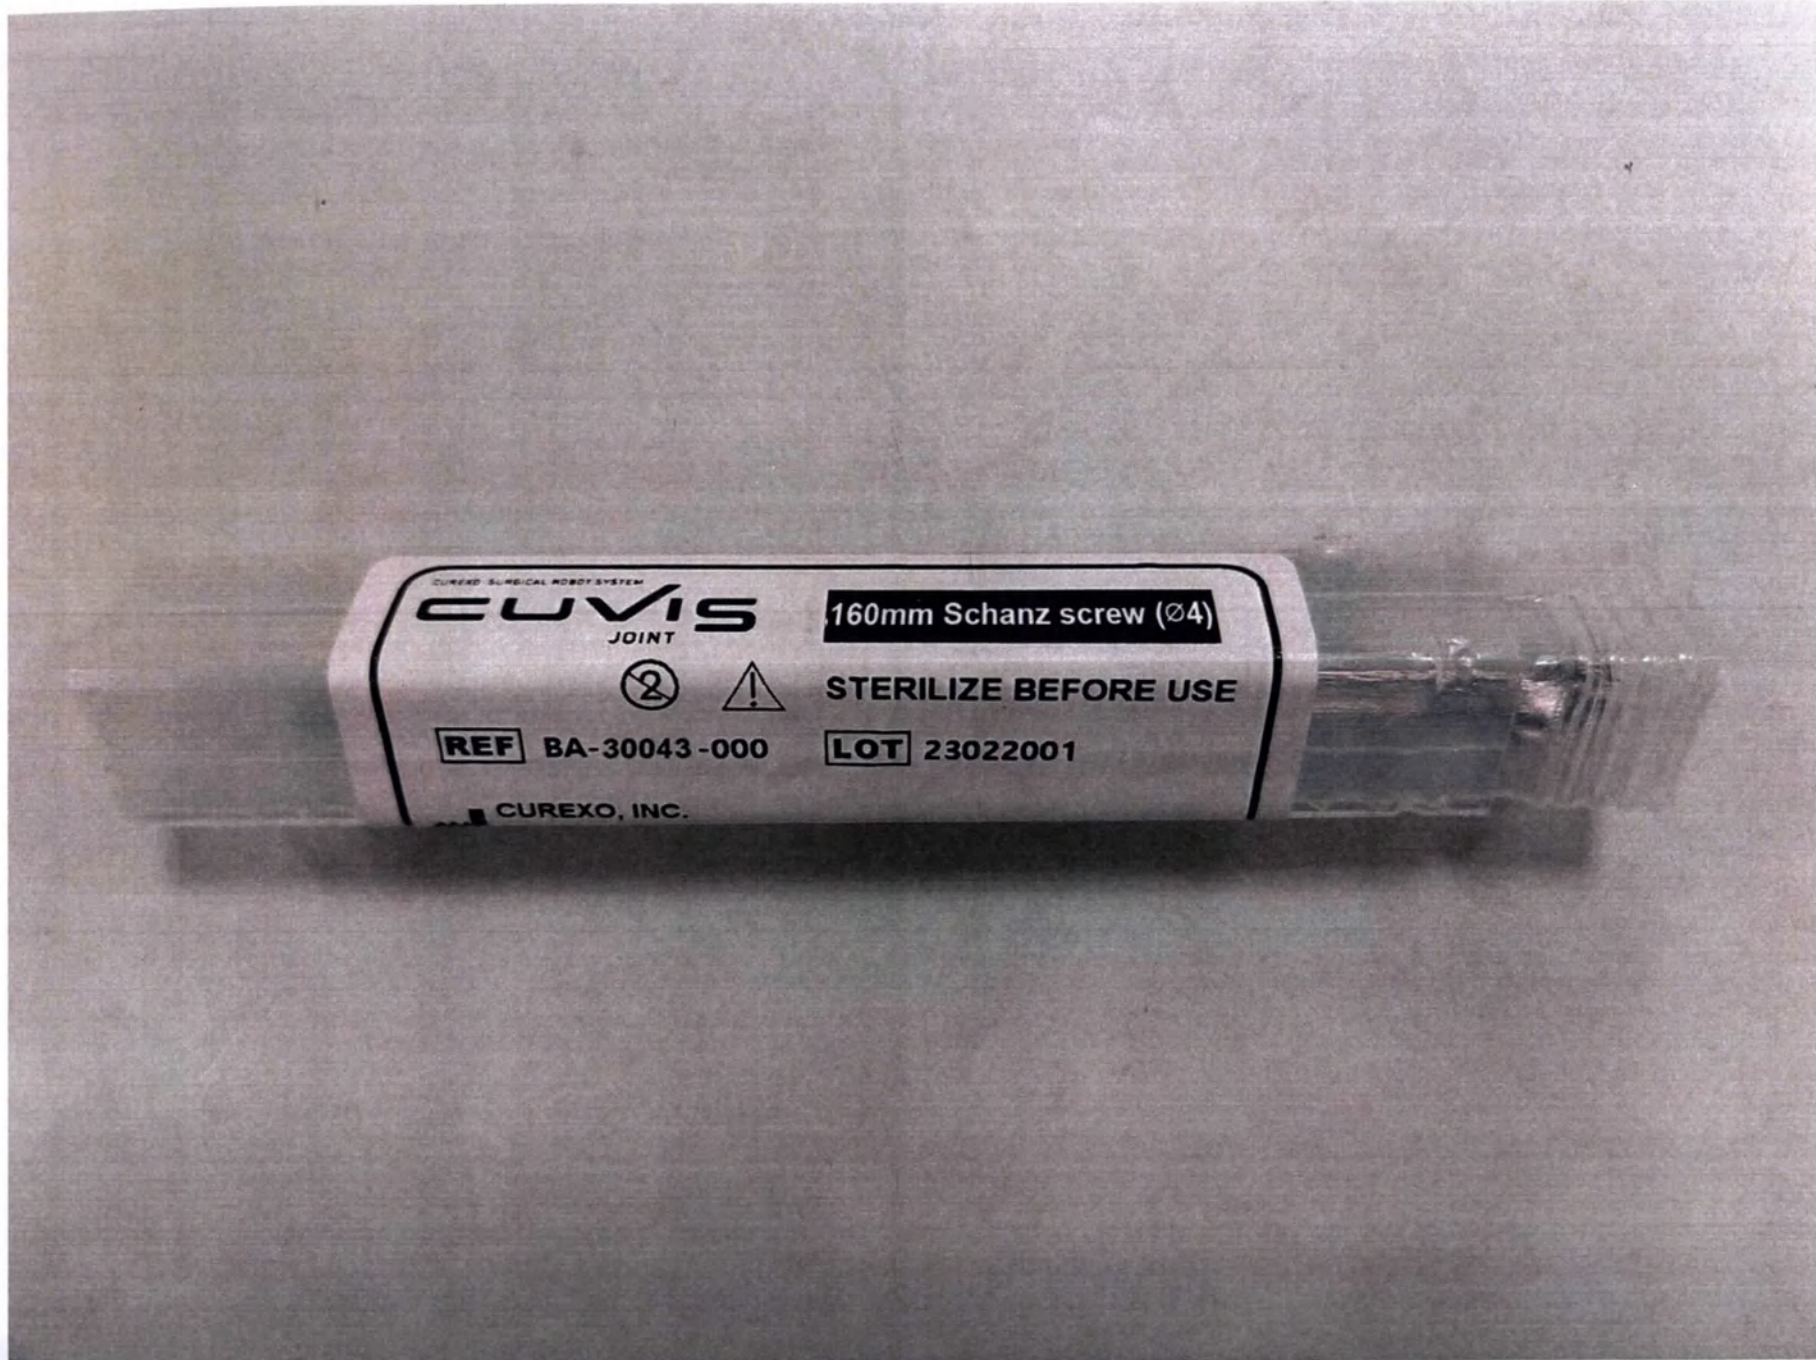


Фото 20 – Упаковка Винта Шанца Ø4, 160 мм BA-30043-000

CUREXO SURGICAL ROBOT SYSTEM

CUVIS
JOINT

Винт Шанца Ø4 , 160мм

Регистрационное
удостоверение:
РУ _____ от _____



**СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

REF BA-30043-000

LOT



CUREXO, INC.
3rd, 4th Floor, 480,
Wiryehunhwan-ro, Songpa-gu,
Seoul, 05814, Republic of Korea

Уполномоченный представитель:
ООО "Аналитика М"
115093, Россия, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 4



(01)08800043860034(11)200317(21)CJ30120100001

Фото 21 – Русскоязычная маркировка Винта Шанца Ø4, 160 мм BA-30043-000

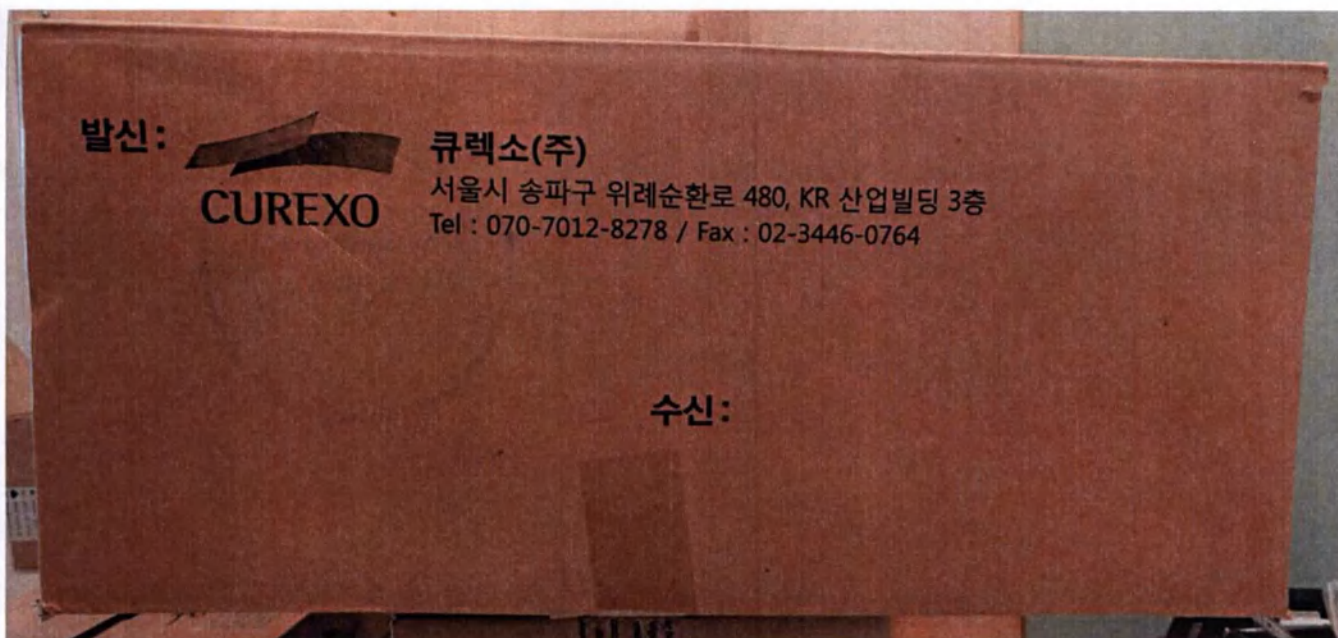


Фото 22 – Транспортная упаковка

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

23 л.

Генеральный директор
Вайсман И.Г.

