



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл» «ИФА-
Трихинеллёз-IgG»

Серия 01 от 26.01.2022г

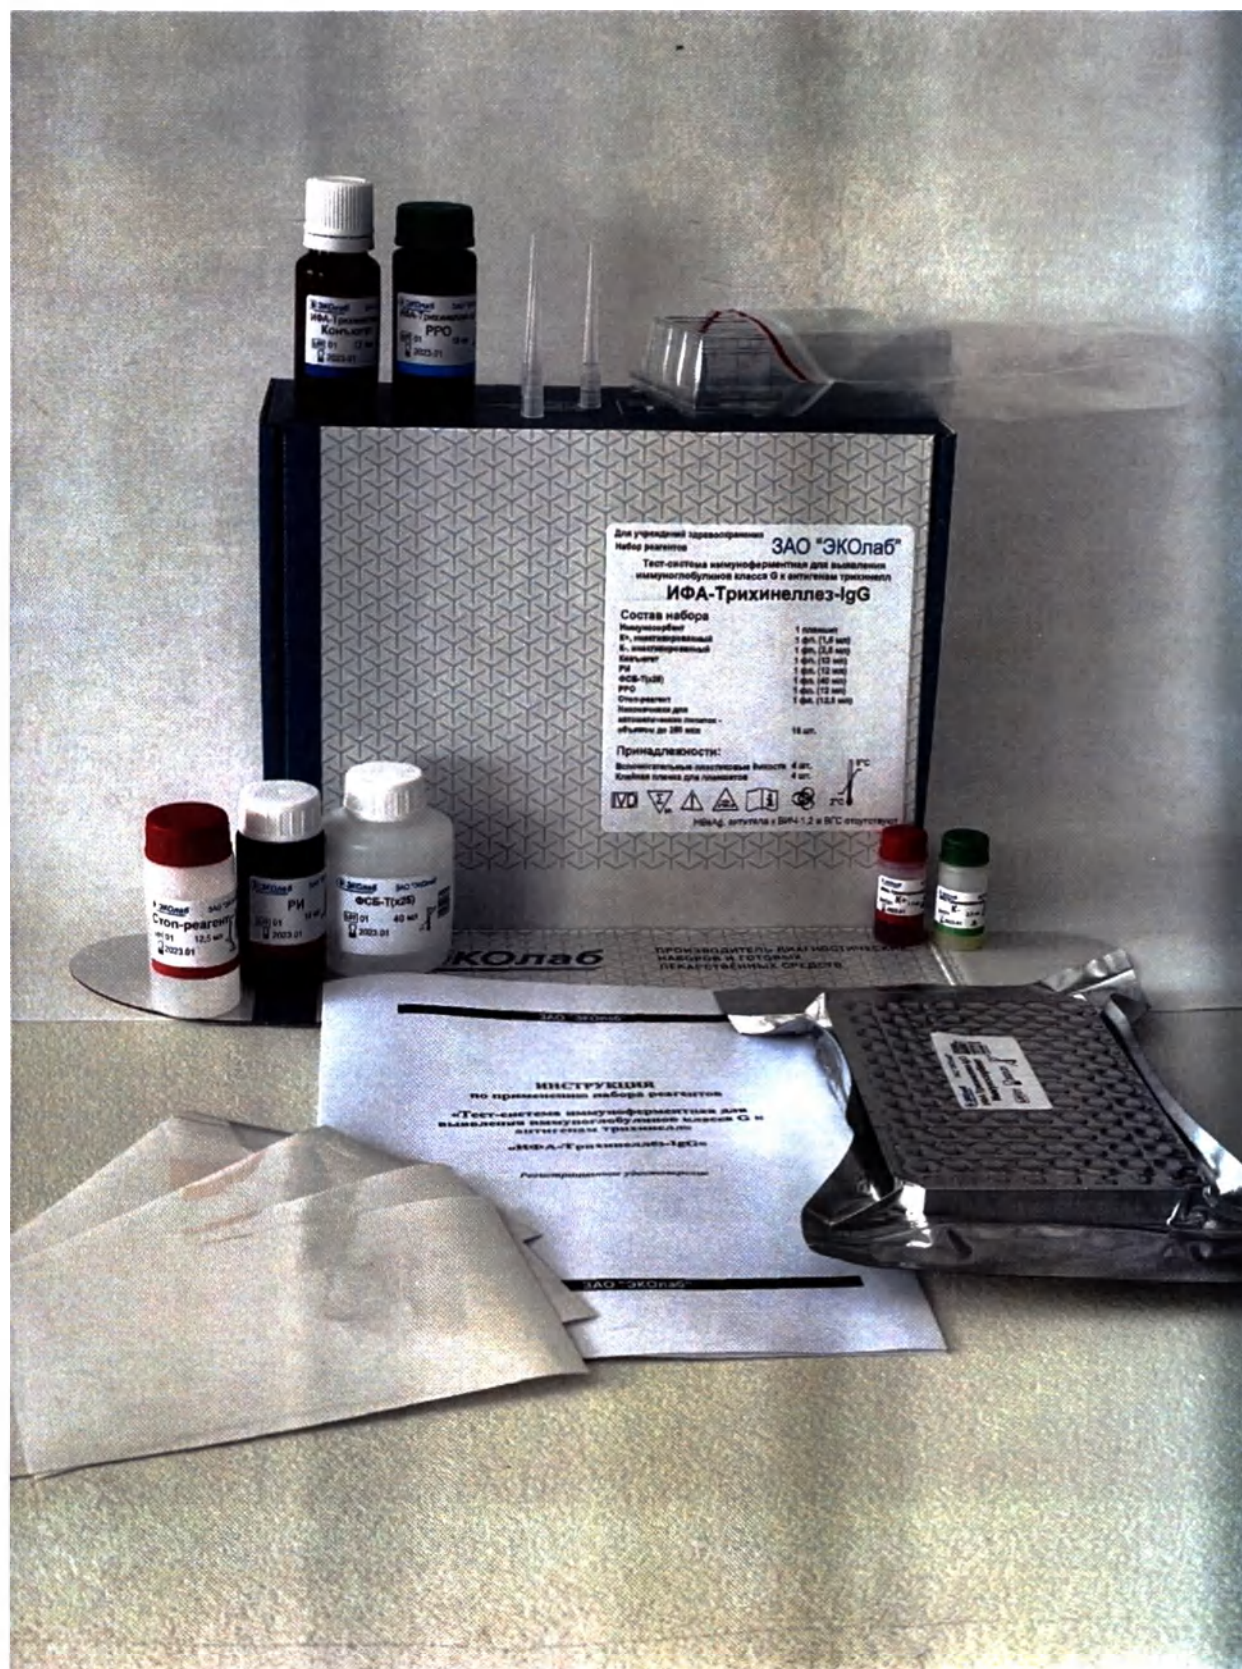

Серия 02 от 27.01.2022г

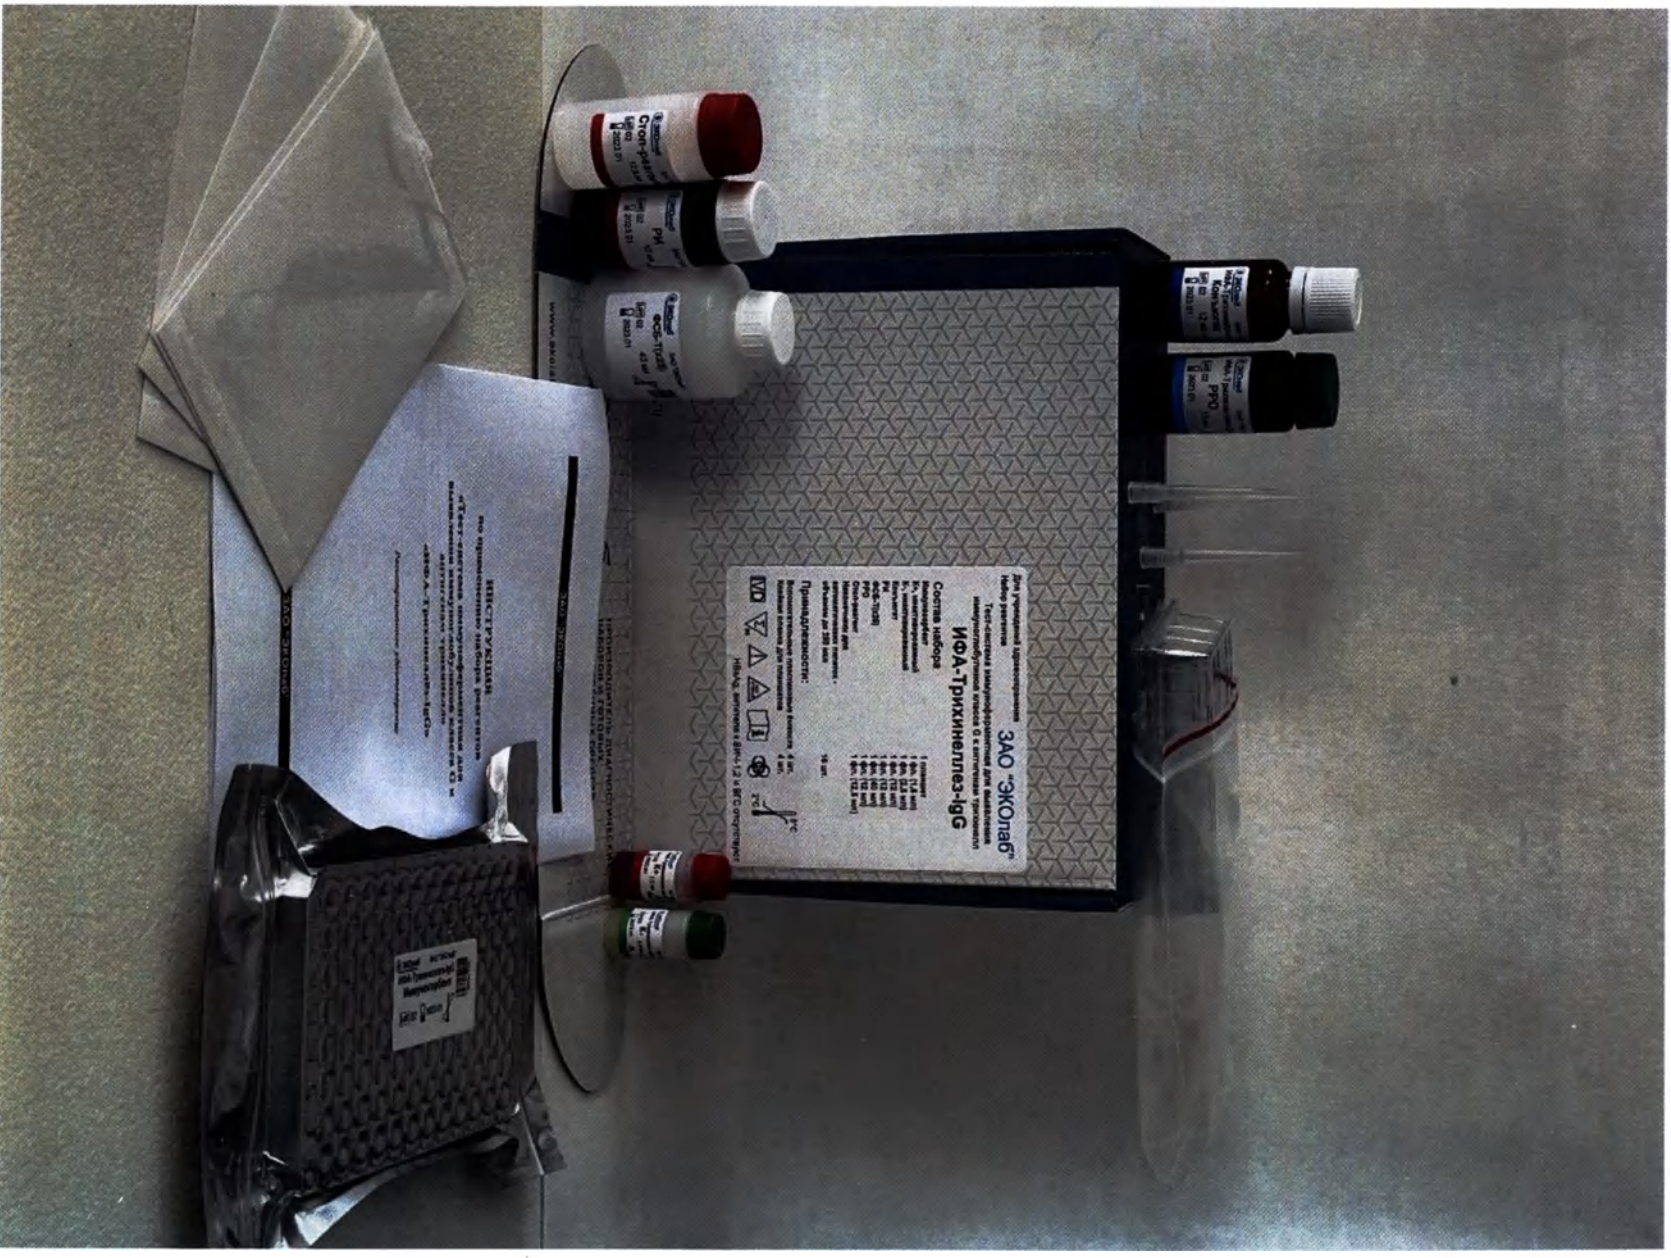

[illegible]

Т.Ю. Ганченко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.



Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл


ИФА-Трихинеллез-IgG

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Наконечники для автоматических пипеток - объемом до 250 мкл	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального
применения

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Трихинеллез-IgG

ТУ 21.20.23-319-70423725-2022,
РУ №


LOT 01

2022.01.26








REF 17.08

2023.01.26

Контрольный № 33



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на коробке

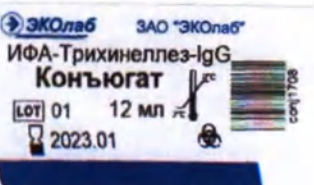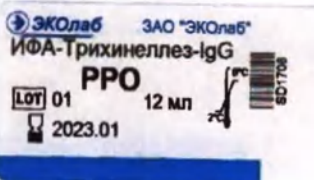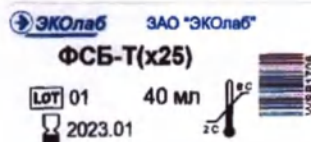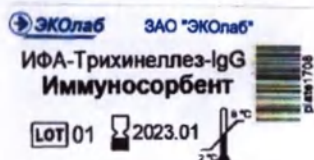

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл


ИФА-Трихинеллез-IgG

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Наконечники для автоматических пипеток - объемом до 250 мкл	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Для профессионального
применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Трихинеллез-IgG

ТУ 21.20.23-319-70423725-2022,
РУ №


LOT 02

2022.01.27







REF 17.08

2023.01.27

Контрольный № 34



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «медицинское изделие для диагностики in vitro» указаны непосредственно на коробке

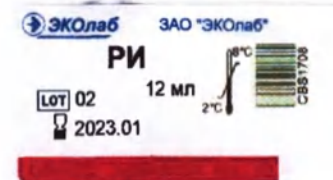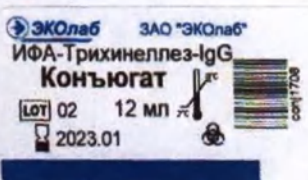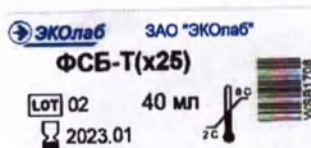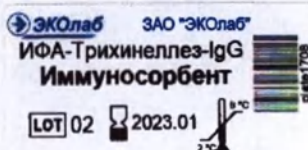

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.

