


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

« 29 » октября 2024 г.

М.П.



Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА»

нестерильные

по ТУ 9398-005-83228278-2013»

2024 г.



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ

200 × 500 мм (липкий слой 200 × 340 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru




Партия №

Дата изг.

Голен до

№ упаковщика



В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные

по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

ЭМАКРИЛ, размер 200х500 мм (липкий слой 200х400 мм)



ООО «ГК ПАЛЬМА»

ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

ЭМАКРИЛ

200 × 500 мм (липкий слой 200 × 400 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru




Партия №

Дата изг.

Голен до

№ упаковщика



В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Макет маркировки медицинского изделия


«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

ЭМАКРИЛ, размер 300х500 мм (липкий слой 300х340 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ

300 × 500 мм (липкий слой 300 × 340 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией


Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485

ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №

Дата изг.

Годен до

№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:


ЭМАКРИЛ, размер 300х500 мм (липкий слой 300х400 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

ЭМАКРИЛ


300 × 500 мм (липкий слой 300 × 400 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика


В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)





ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ

400 × 500 мм (липкий слой 400 × 340 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией


Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485

ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №

Дата изг.

Годеи до

№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия


«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

ЭМАКРИЛ, размер 400х500 мм (липкий слой 400х400 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ


400 × 500 мм (липкий слой 400 × 400 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика


В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)





ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ


500 × 500 мм (липкий слой 500 × 340 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru




Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ЭМАКРИЛ


500 × 500 мм (липкий слой 500 × 400 мм), 5 штук



НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Голен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)






ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ для длительных операций


200 × 500 мм (липкий слой 200 × 340 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Голен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:


СИЛАКРИЛ, размер 200х500 мм (липкий слой 200х400 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ для длительных операций


200 × 500 мм (липкий слой 200 × 400 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные

по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

СИЛАКРИЛ, размер 300х500 мм (липкий слой 300х340 мм)



ООО «ГК ПАЛЬМА»


ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

СИЛАКРИЛ

для длительных операций

300 × 500 мм (липкий слой 300 × 340 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годеи до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные

по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:


СИЛАКРИЛ, размер 300х500 мм (липкий слой 300х400 мм)



ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ для длительных операций


300 × 500 мм (липкий слой 300 × 400 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

СИЛАКРИЛ, размер 400х500 мм (липкий слой 400х340 мм)




ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

СИЛАКРИЛ

для длительных операций


400 × 500 мм (липкий слой 400 × 340 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от ХХ.ХХ.ХХХХ
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Голен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Макет маркировки медицинского изделия

«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные

по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

СИЛАКРИЛ, размер 400х500 мм (липкий слой 400х400 мм)




ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ

СИЛАКРИЛ

для длительных операций


400 × 500 мм (липкий слой 400 × 400 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
«ответственность
(при необходимости)»





ООО «ГК ПАЛЬМА»


ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ для длительных операций

500 × 500 мм (липкий слой 500 × 340 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО

ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Годен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)






ПЛЕНКА ЛИПКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИЛАКРИЛ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ


500 × 500 мм (липкий слой 500 × 400 мм), 5 штук

НЕСТЕРИЛЬНО



ПЛЕНКИ ЛИПКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ «ПАЛЬМА» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
Предназначены для комплектования хирургических наборов и комплектов с их последующей стерилизацией
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485
ТУ 9398-005-83228278-2013 Рег. уд. № РЗН 2014/1403 от XX.XX.XXXX
Утилизируется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б
Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево,
ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, www.palma-med.ru



Партия №
Дата изг.
Голен до
№ упаковщика

В этой части
допускается
указывать
знак
соответствия
(при необходи-
мости)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 17

(семнадцать) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«29» октября 2024 г.

МП



Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

« 29 » октября 2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные
по ТУ 9398-005-83228278-2013»

2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 ЭМАКРИЛ, размер 200х500 мм (липкий слой 200х340 мм и 200х400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 ЭМАКРИЛ, размер 300x500 мм (липкий слой 300x340 мм и 300x400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:

ЭМАКРИЛ, размер 400x500 мм (липкий слой 400x340 мм и 400x400 мм)

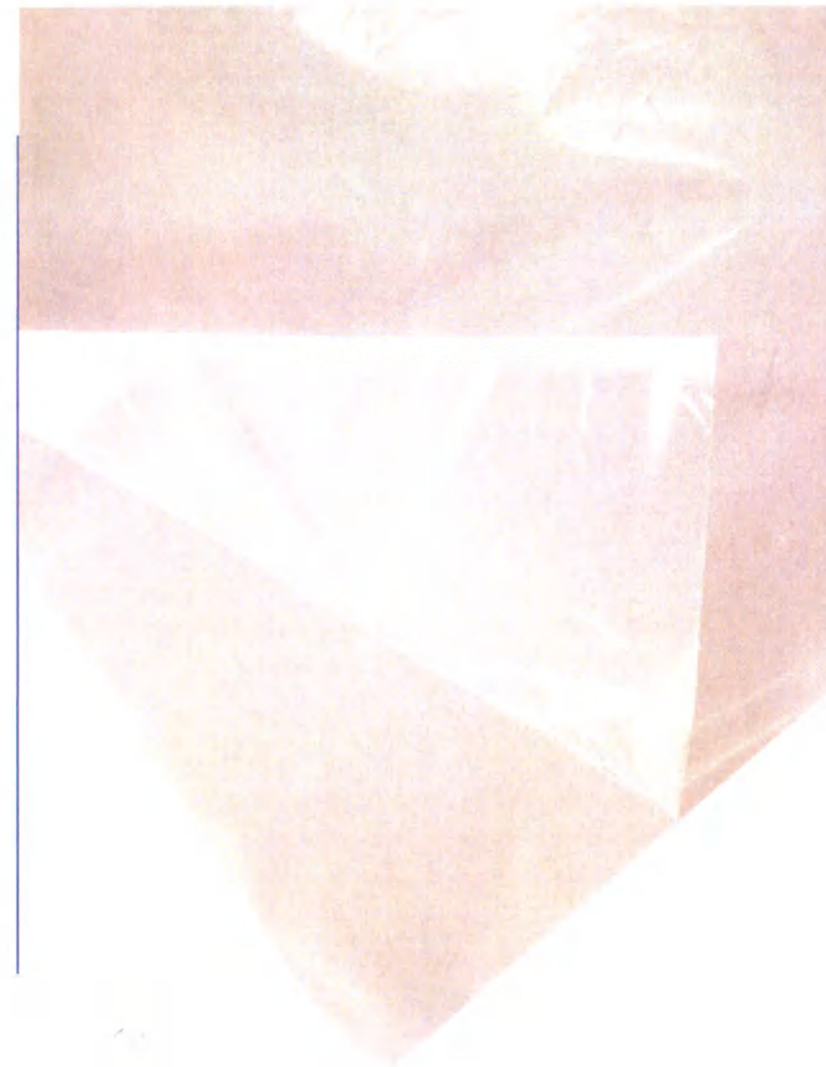

Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 ЭМАКРИЛ, размер 500х500 мм (липкий слой 500х340 мм и 500х400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 СИЛАКРИЛ, размер 200x500 мм (липкий слой 200x340 мм и 200x400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 СИЛАКРИЛ, размер 300x500 мм (липкий слой 300x340 мм и 300x400 мм)




Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 СИЛАКРИЛ, размер 400х500 мм (липкий слой 400х340 мм и 400х400 мм)



Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Пленки липкие операционные «ПАЛЬМА» нестерильные по ТУ 9398-005-83228278-2013» в исполнении:
 СИЛАКРИЛ, размер 500х500 мм (липкий слой 500х340 мм и 500х400 мм)

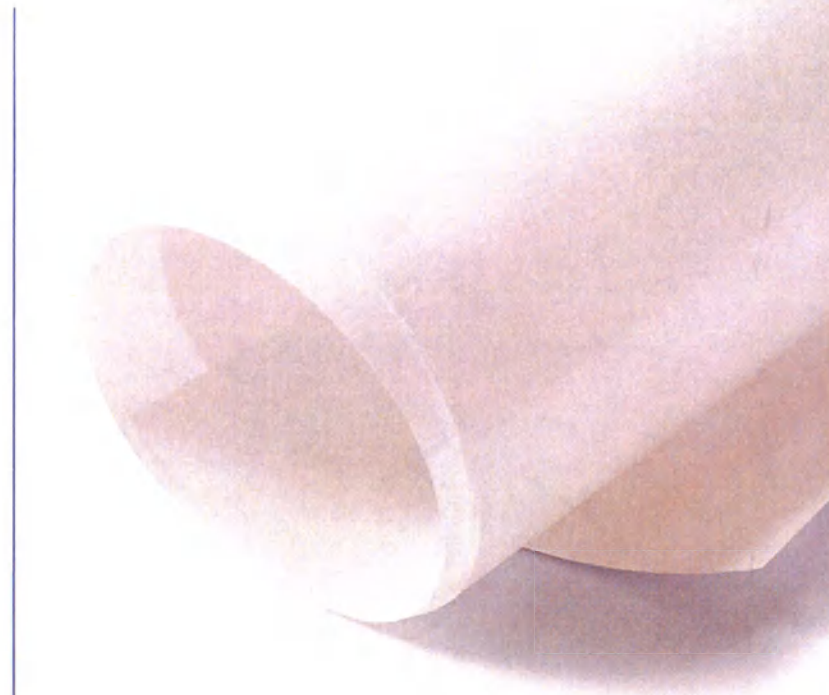

Примечание: размер и цветопередача могут отличаться от оригинала

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 9

(девять) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«29» октября 2024 г.

