

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

« 21 » октября 2024 г.



Макеты маркировки и упаковки медицинского изделия

«Система двухкомпонентная для ухода за стомой

БИНАЦЕЛ®-КОЛО

по

ТУ 32.50.13-012-83228278-2019»

2024 г.


1. Макет упаковки и маркировки медицинского изделия «Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-КОЛО по ТУ 32.50.13-012-83228278-2019»:

1.1 Макеты упаковок Емкостей колостомных БИНАЦЕЛ®КОЛО:

1.1.1 Макет упаковки «Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО прозрачная» для исполнений:

- БИНАЦЕЛ®-КОЛО прозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО прозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ПРИМА КОЛО прозрачная;

Дизайн упаковки № 1:

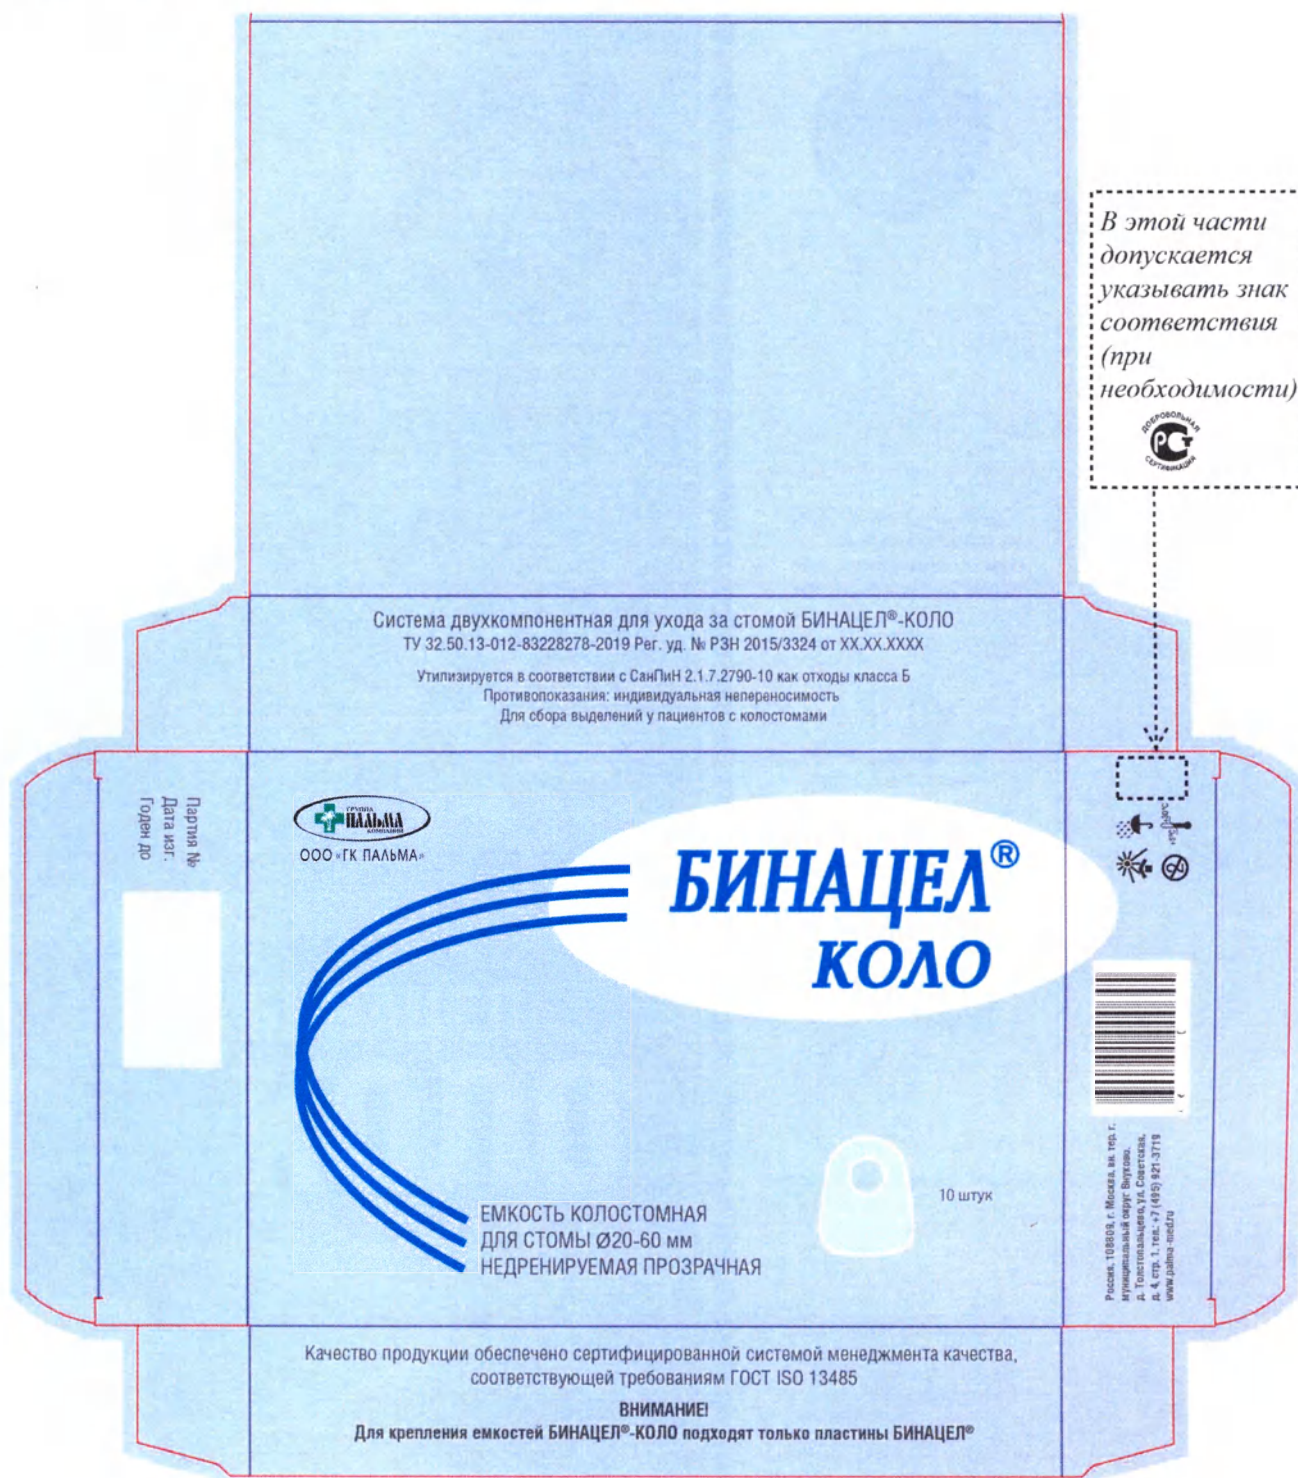


Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

2

Дизайн упаковки № 2:

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)



Качество продукции обеспечивается сертифицированными
системой менеджмента качества.
Согласно требованиям технического регламента Еurasian Conformity (TCCT ISO 13485)
Для сбора выданных у клиентов с комплектом
Упаковка соответствует требованиям с Санитарии
2.1.7.2780-10 как медицинская упаковка
Противопоказаний, противопоказаний и противопоказаний



Для дополнительной фиксации
предлагается использовать
полоску БИНАЦЕЛ®



СИСТЕМА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ
УХОДА ЗА СТОМОЙ БИНАЦЕЛ® КОЛО
Reg. Уд. № РЗН 2015/3324 от XX.XX.XX
ТУ 32.50.13-012-83228278-2019




ЕМКОСТЬ КОЛОСТОМНАЯ
ДЛЯ СТОМЫ Ø 20-60 мм

БИНАЦЕЛ® КОЛО

ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

10

ЕМКОСТЕЙ
ДЛЯ УХОДА ЗА СТОМОЙ



ПРОЗРАЧНАЯ НЕДРЕНИРУЕМАЯ

МЯГКИЙ СЕТЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ
С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Партия №
Дата изг.
Годен до




Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская,
д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719,
www.palma-med.ru

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.1.2 Макет упаковки «Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО непрозрачная» для исполнений систем:

- БИНАЦЕЛ®-КОЛО непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ПРИМА КОЛО непрозрачная;



Дизайн упаковки № 1:

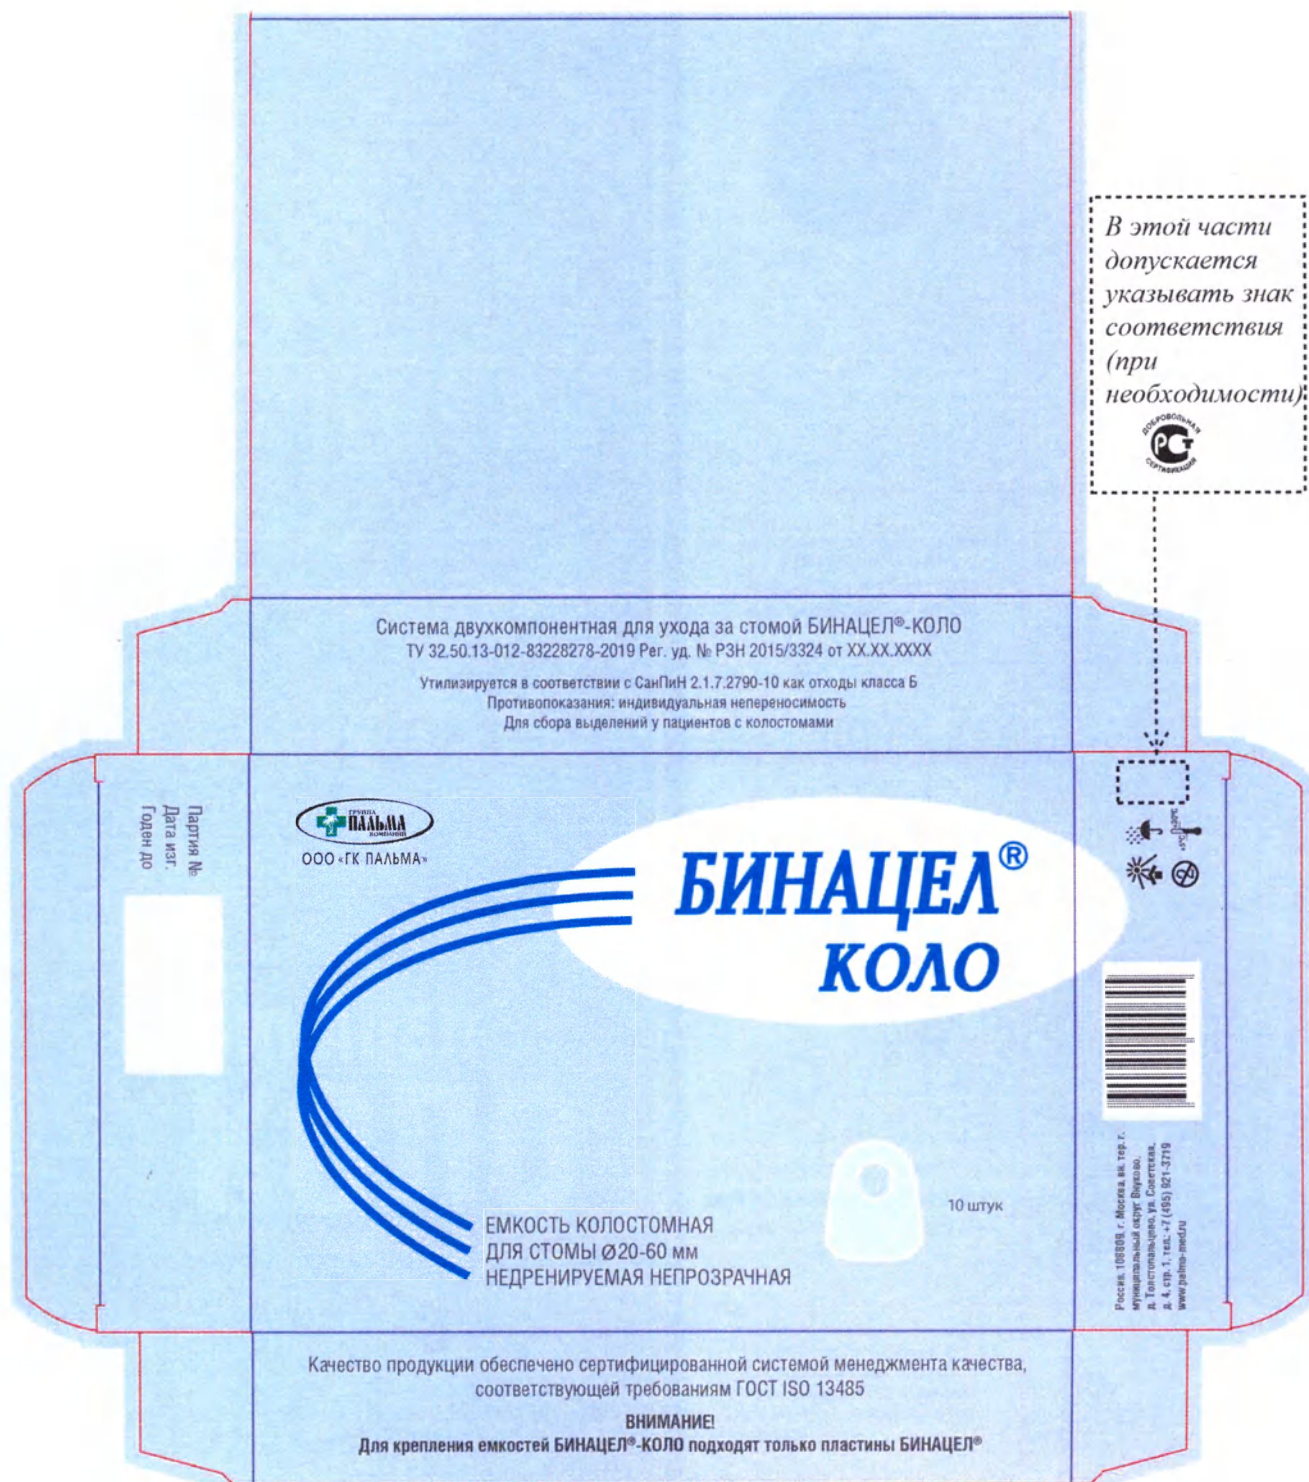

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Дизайн упаковки № 2:

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)

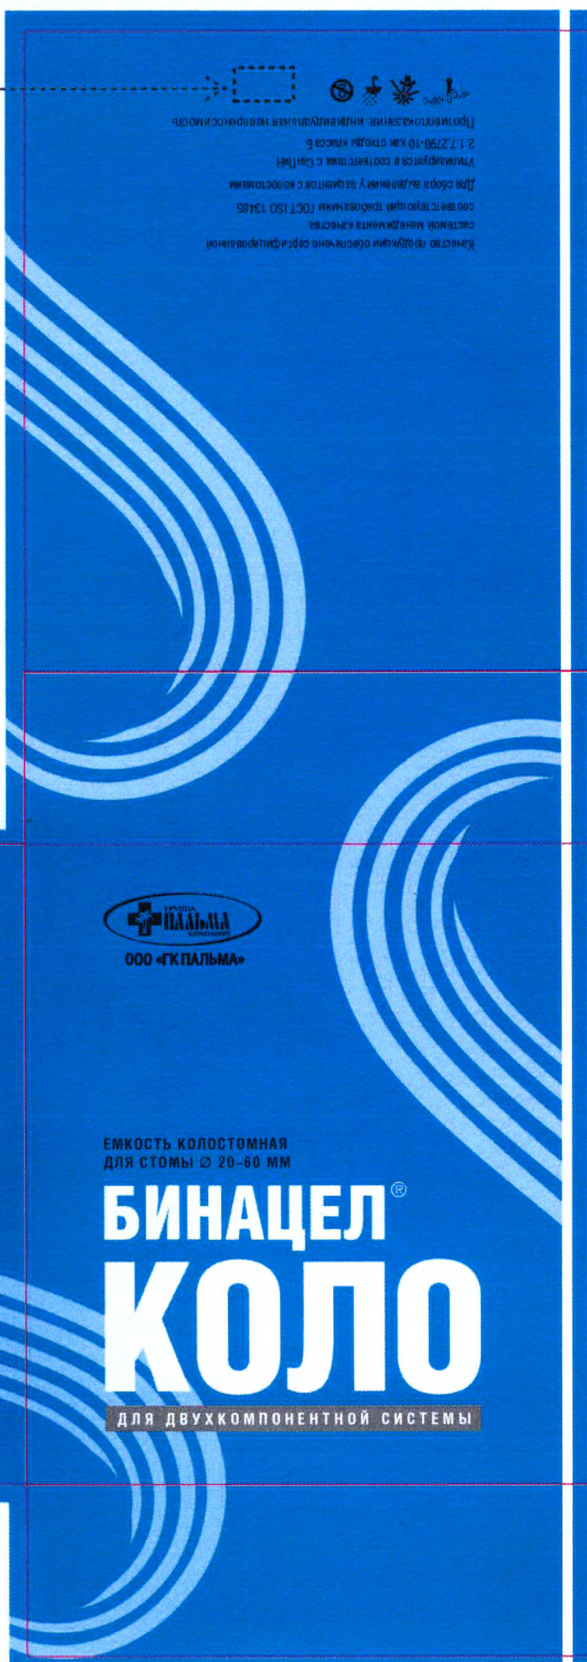


Для дополнительной фиксации
предлагается воспользоваться
ПО ВСЕМ БИНАЦЕЛ



СИСТЕМА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ
УХОДА ЗА СТОМОЙ БИНАЦЕЛ КОЛО
ТУ 32.50.13-012-83228278-2019
Рег. укл. №РЗН 2015/3324 от XX.XX.XX

10

ЕМКОСТЕЙ
для ухода за стомой



НЕПРОЗРАЧНАЯ НЕДРЕНИРУЕМАЯ

МЯГКИЙ СЕТЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ
С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Партия №
Дата изг.
Годен до



Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская,
д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719,
www.palma-med.ru

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.1.3 Макет упаковки «Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО+ непрозрачная» для исполнений систем:

- БИНАЦЕЛ®-КОЛО+ непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО+ непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ПРИМА КОЛО+ непрозрачная;

Дизайн упаковки № 1:




Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Дизайн упаковки № 2:

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)



Качество продукции обеспечено сертифицированным
системой менеджмента качества
соответствующей требованиям ГОСТ ISO 19001
Для сбора выводов и подтверждения с соответствием
Удостоверяется в соответствии с СанПиН
2.1.2.796-10 как отходы класса B
Противопоказано: индивидуальная непереносимость



Для дополнительной фиксации
предлагаем воспользоваться
ПОЛОСКОЙ БИНАЦЕЛ®



СИСТЕМА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ДЛЯ
УХОДА ЗА СТОМОЙ БИНАЦЕЛ®-КОЛО
Рег. уд. № РЗН 2015/3324 от XX.XX.XX
РЗ 32.50.13-012-83228278-2019




ЕМКОСТЬ КОЛОСТОМНАЯ
для стомы Ø 20-60 мм

БИНАЦЕЛ® КОЛО+

ДЛЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

10

ЕМКОСТЕЙ
для ухода за стомой



НЕПРОЗРАЧНАЯ НЕДРЕНИРУЕМАЯ
МЯГКИЙ СЕТЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ
С ДВУХ СТОРОН

Партия №
Дата изг.
Годен до




Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская,
д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719.
www.palma-med.ru

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.2 Макеты упаковок Пластин БИНАЦЕЛ®:
 1.2.2 Макет упаковки «Пластина БИНАЦЕЛ®» для исполнений систем: - БИНАЦЕЛ®-КОЛО прозрачная; - БИНАЦЕЛ® КОЛО непрозрачная; - БИНАЦЕЛ® КОЛО+ непрозрачная;
 Дизайн упаковки № 1:



Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

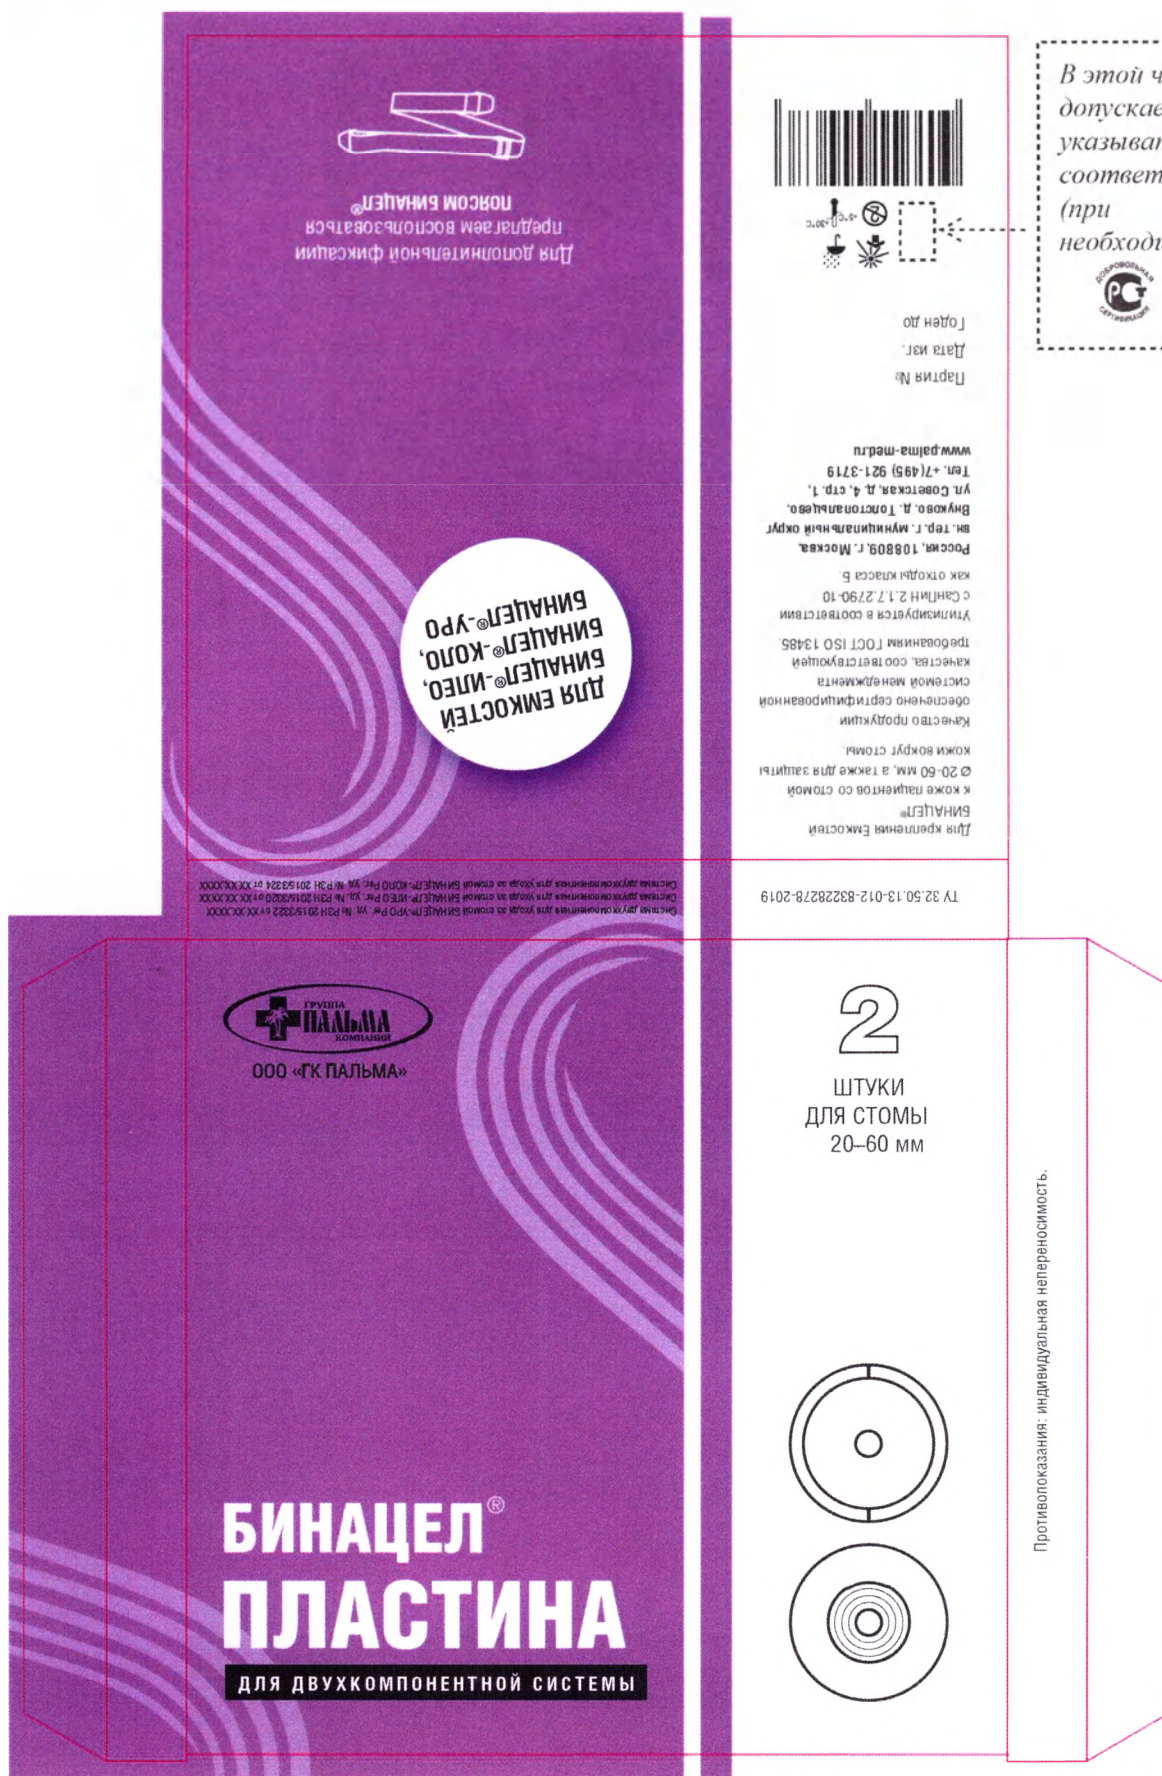

В этой части
допускается
указывать знак
соответствия
(при
необходимости)



1.2.3 Макет упаковки «Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА» для исполнений:

- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО прозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО+ непрозрачная:

Дизайн упаковки № 1:




Примечание: размер и цвет упаковки могут отличаться от оригинала

1010

1.2.4 Макет упаковки «Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА» для исполнений систем:

- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО прозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО непрозрачная;
- БИНАЦЕЛ®ОПТИМА КОЛО+ непрозрачная;


Дизайн упаковки № 1:

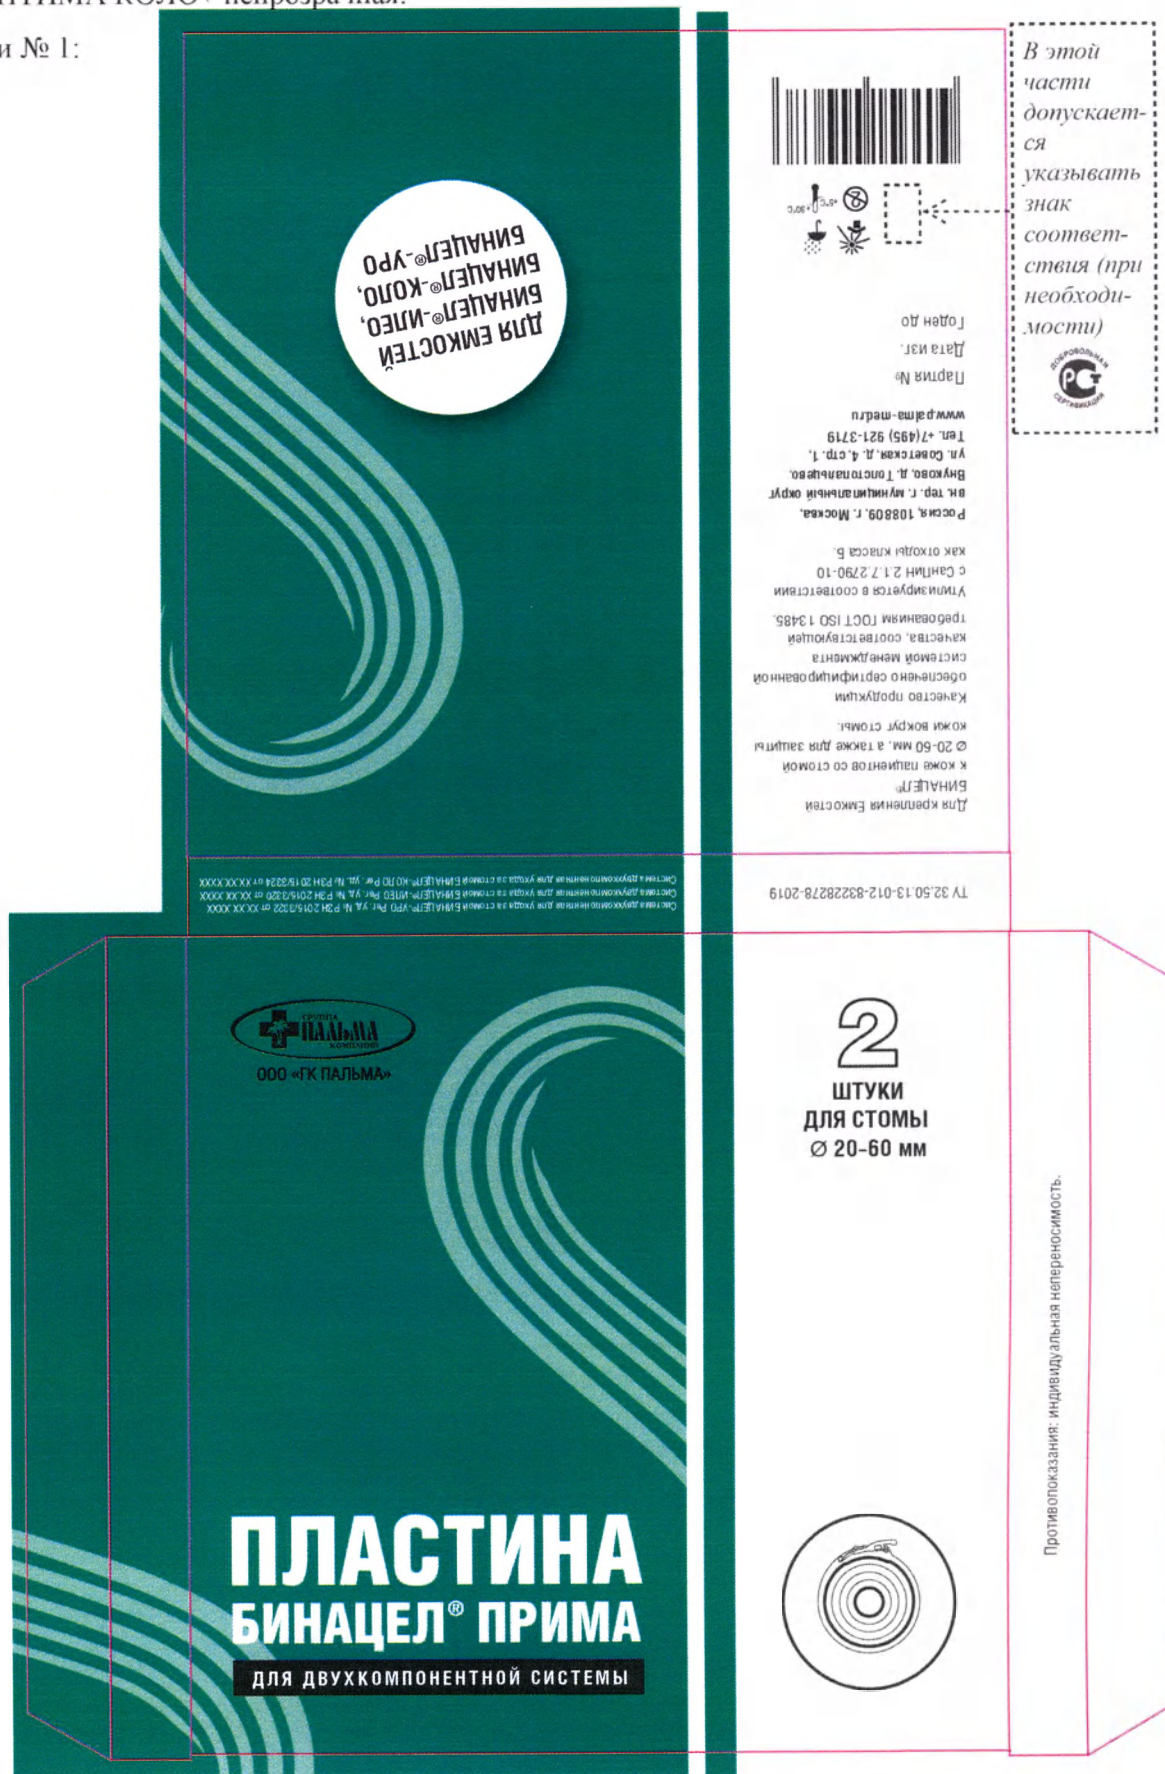

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

2. Макеты упаковок принадлежностей для медицинского изделия «Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-КОЛО по ТУ 32.50.13-019-83228278-2019».

2.1. Полуколыцо СОФАЛЬ, адгезивное:

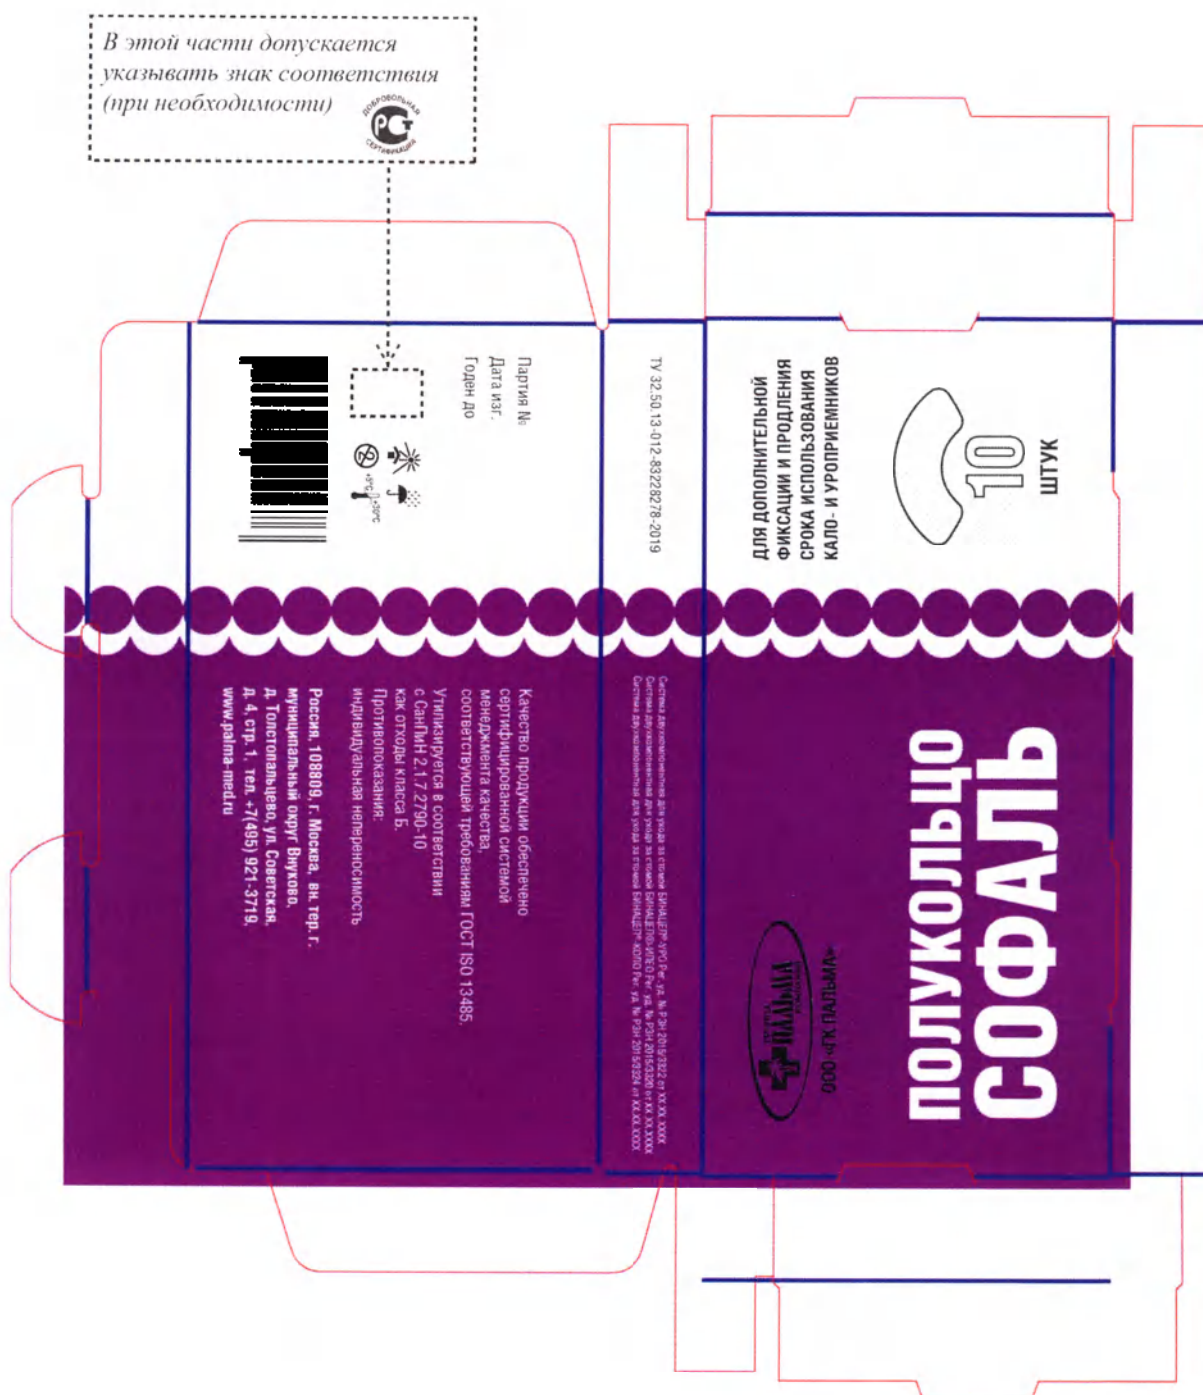

2.2. Полукольцо СОФАЛЬ А, адгезивное:

В этой части допускается
указывать знак соответствия
(при необходимости)





ООО «ГК ПАЛЬМА»

Пояс БИНАЦЕЛ® 1 штука

Предназначен для дополнительной фиксации систем
двухкомпонентных для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®

Инструкция по применению

Пояс крепится **после** присоединения ёмкости к пластине

- Отрегулируйте пояс по размеру
- Присоедините пояс, вставив крючки на его концах в отверстия боковых ушек фланцевого замка ёмкости


Партия №

Дата изг.

Годен до



Россия, 108809, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Внуково,
д. Толстопальцево, ул. Советская,
д. 4, стр. 1, тел. +7 (495) 921-3719,
www.palma-med.ru



Противопоказания: индивидуальная непереносимость

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества,
соответствующей требованиям ГОСТ ISO 13485

ТУ 32.50.13-012-83228278-2019

Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ® - ИЛЕО Рег. уд. № РЗН 2015/3320 от XX.XX.XXXX

Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ® - КОЛО Рег. уд. № РЗН 2015/3324 от XX.XX.XXXX

Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ® - УРО Рег. уд. № РЗН 2015/3322 от XX.XX.XXXX

В этой части допускается
указывать знак соответствия
(при необходимости)



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 14

(четырнадцать) листа(ов)

Генеральный директор

ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«21» октября 2024 г.

МП



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Б.Ю. Бронштейн

«21» октября 2024 г




Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия
«Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-КОЛО
по
ТУ 32.50.13-012-83228278-2019»

2024 г.


1. Фотографическое изображения общего вида медицинского изделия «Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-КОЛО по ТУ 32.50.13-012-83228278-2019», в исполнении:

1.1 Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО, прозрачная:

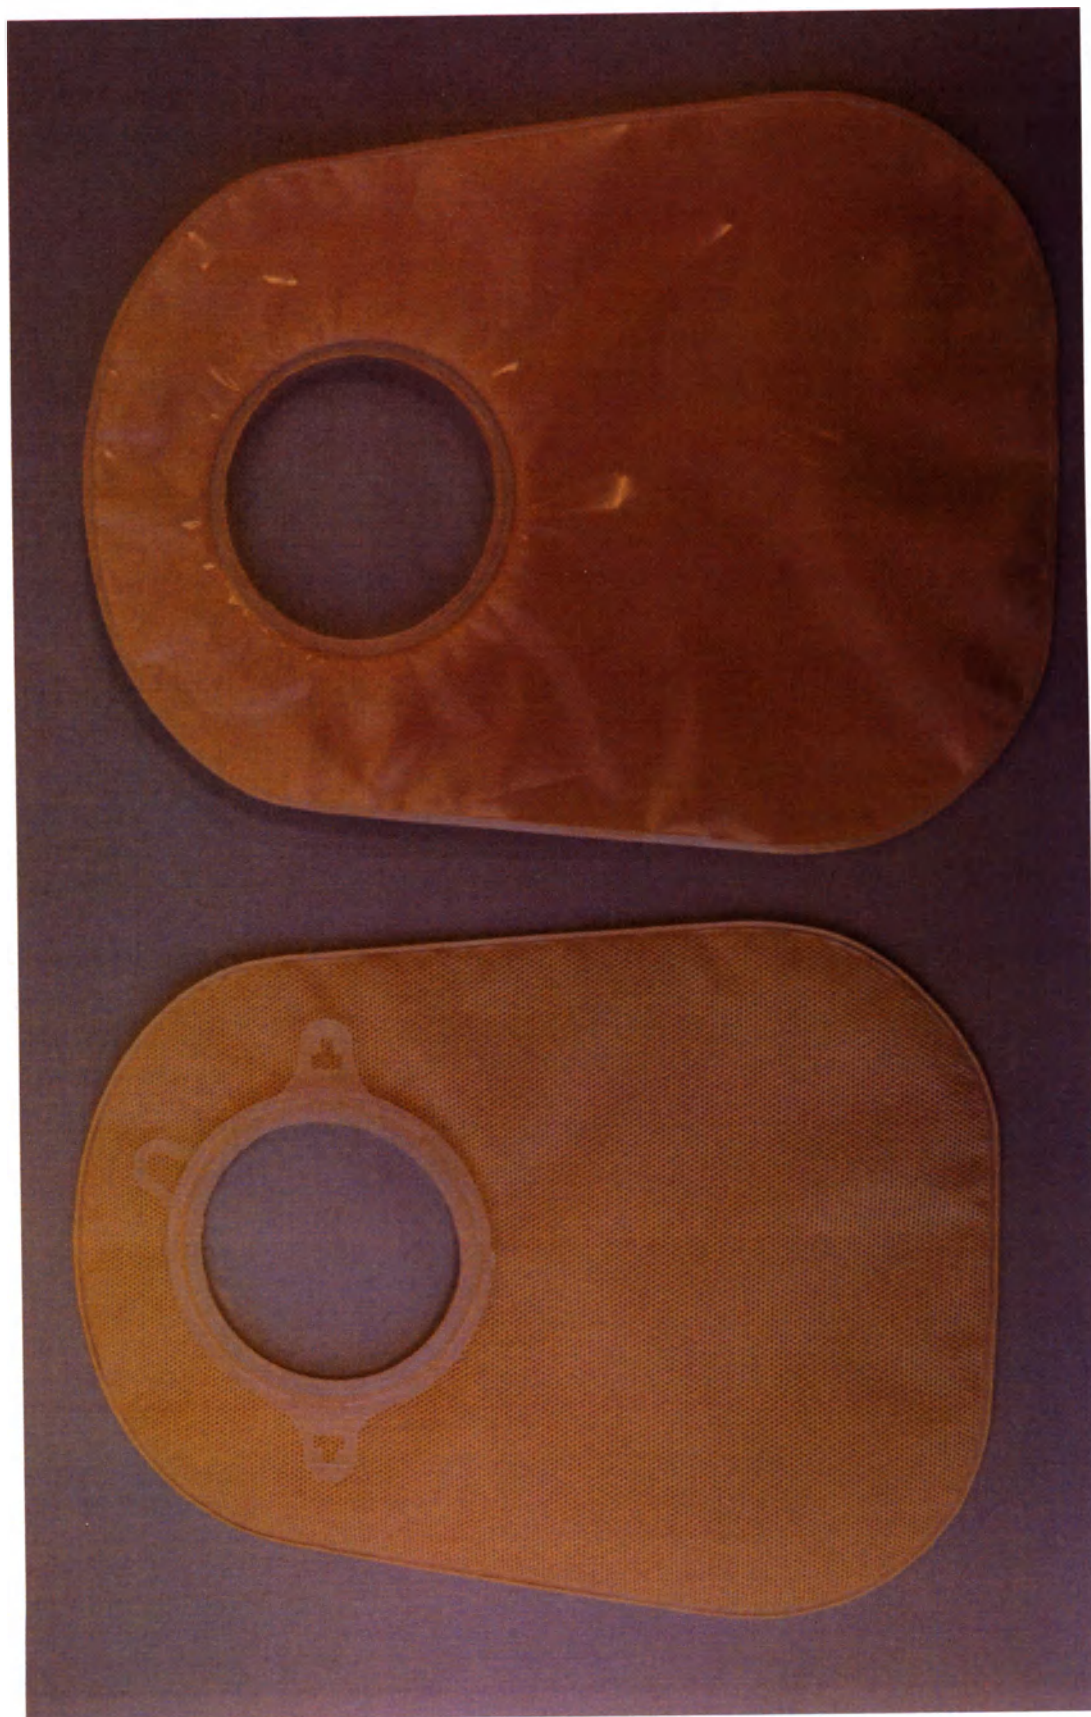


Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.2 Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО, непрозрачная

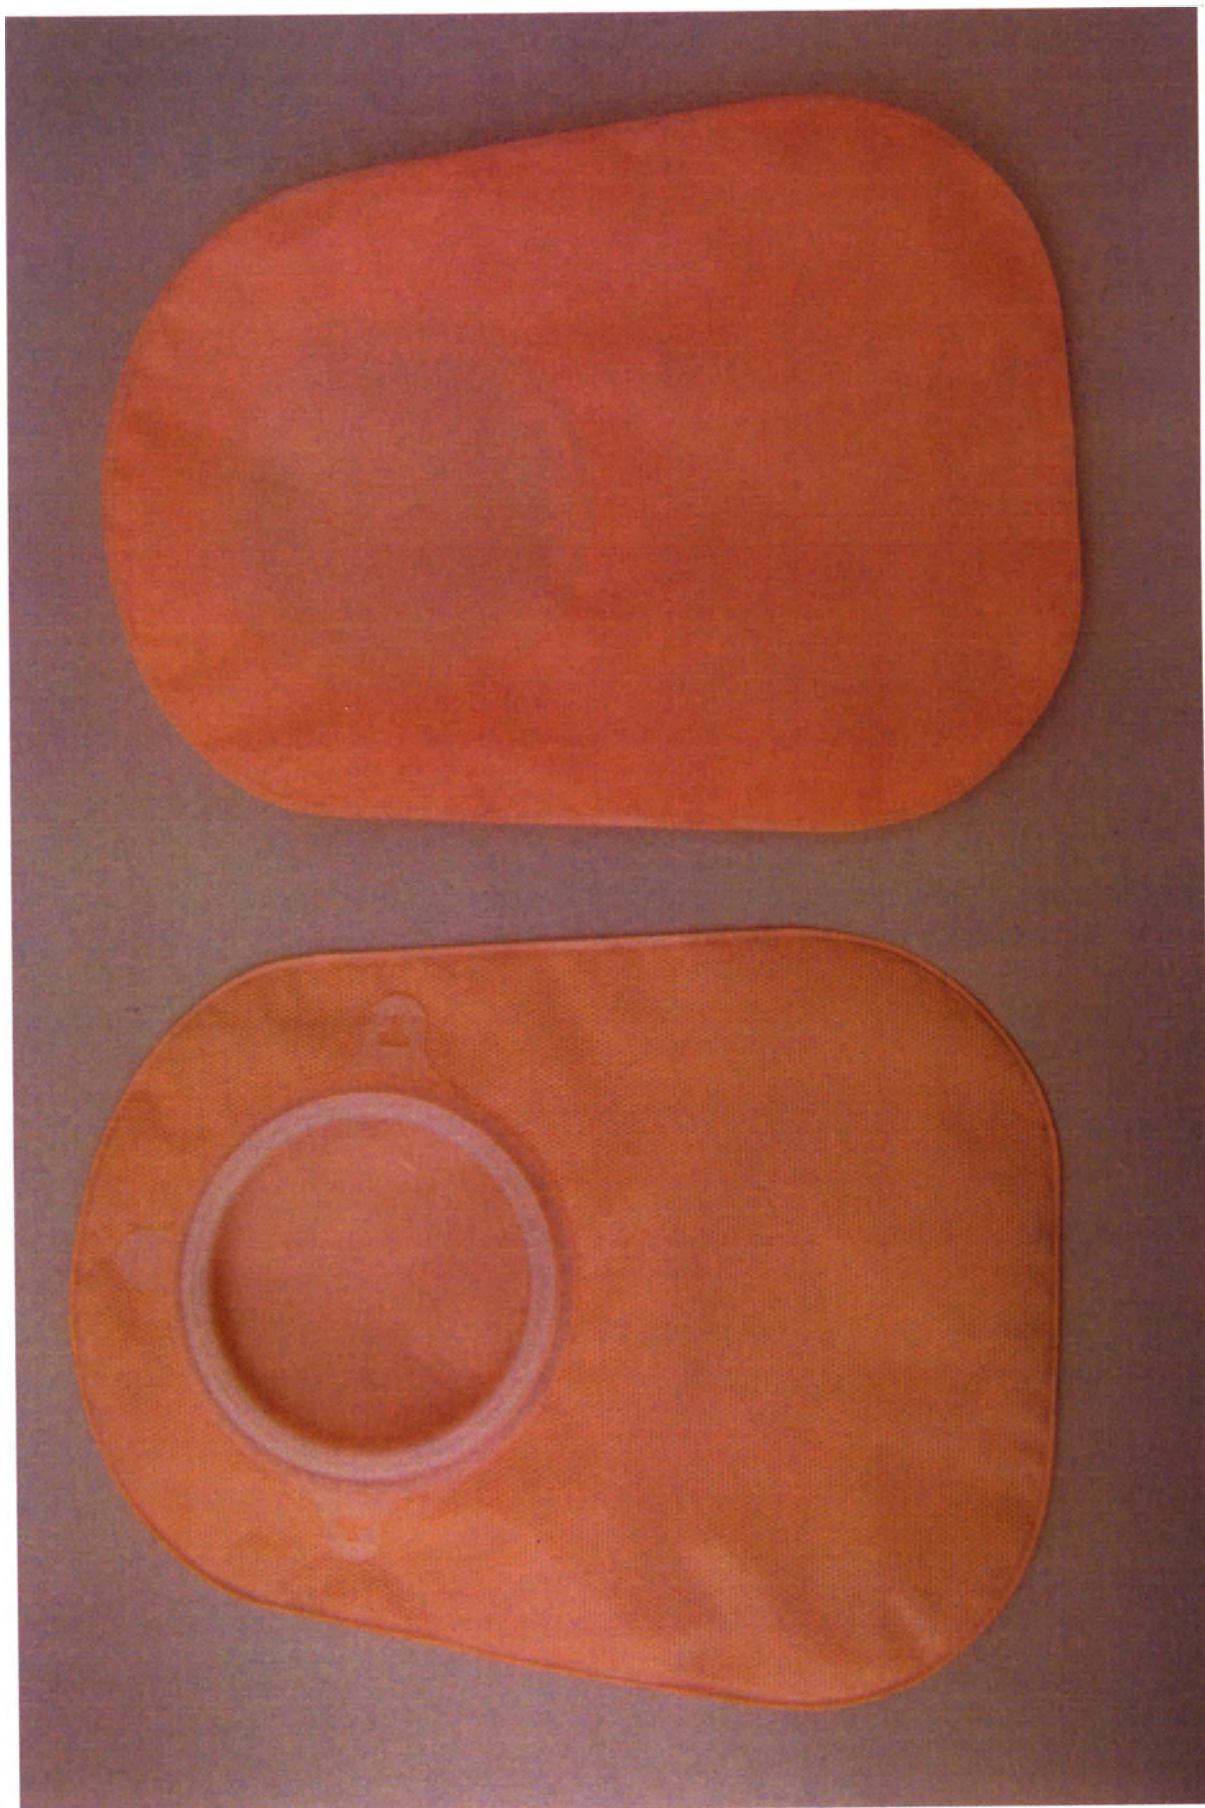


Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.3 Емкость колостомная БИНАЦЕЛ®-КОЛО+, непрозрачная

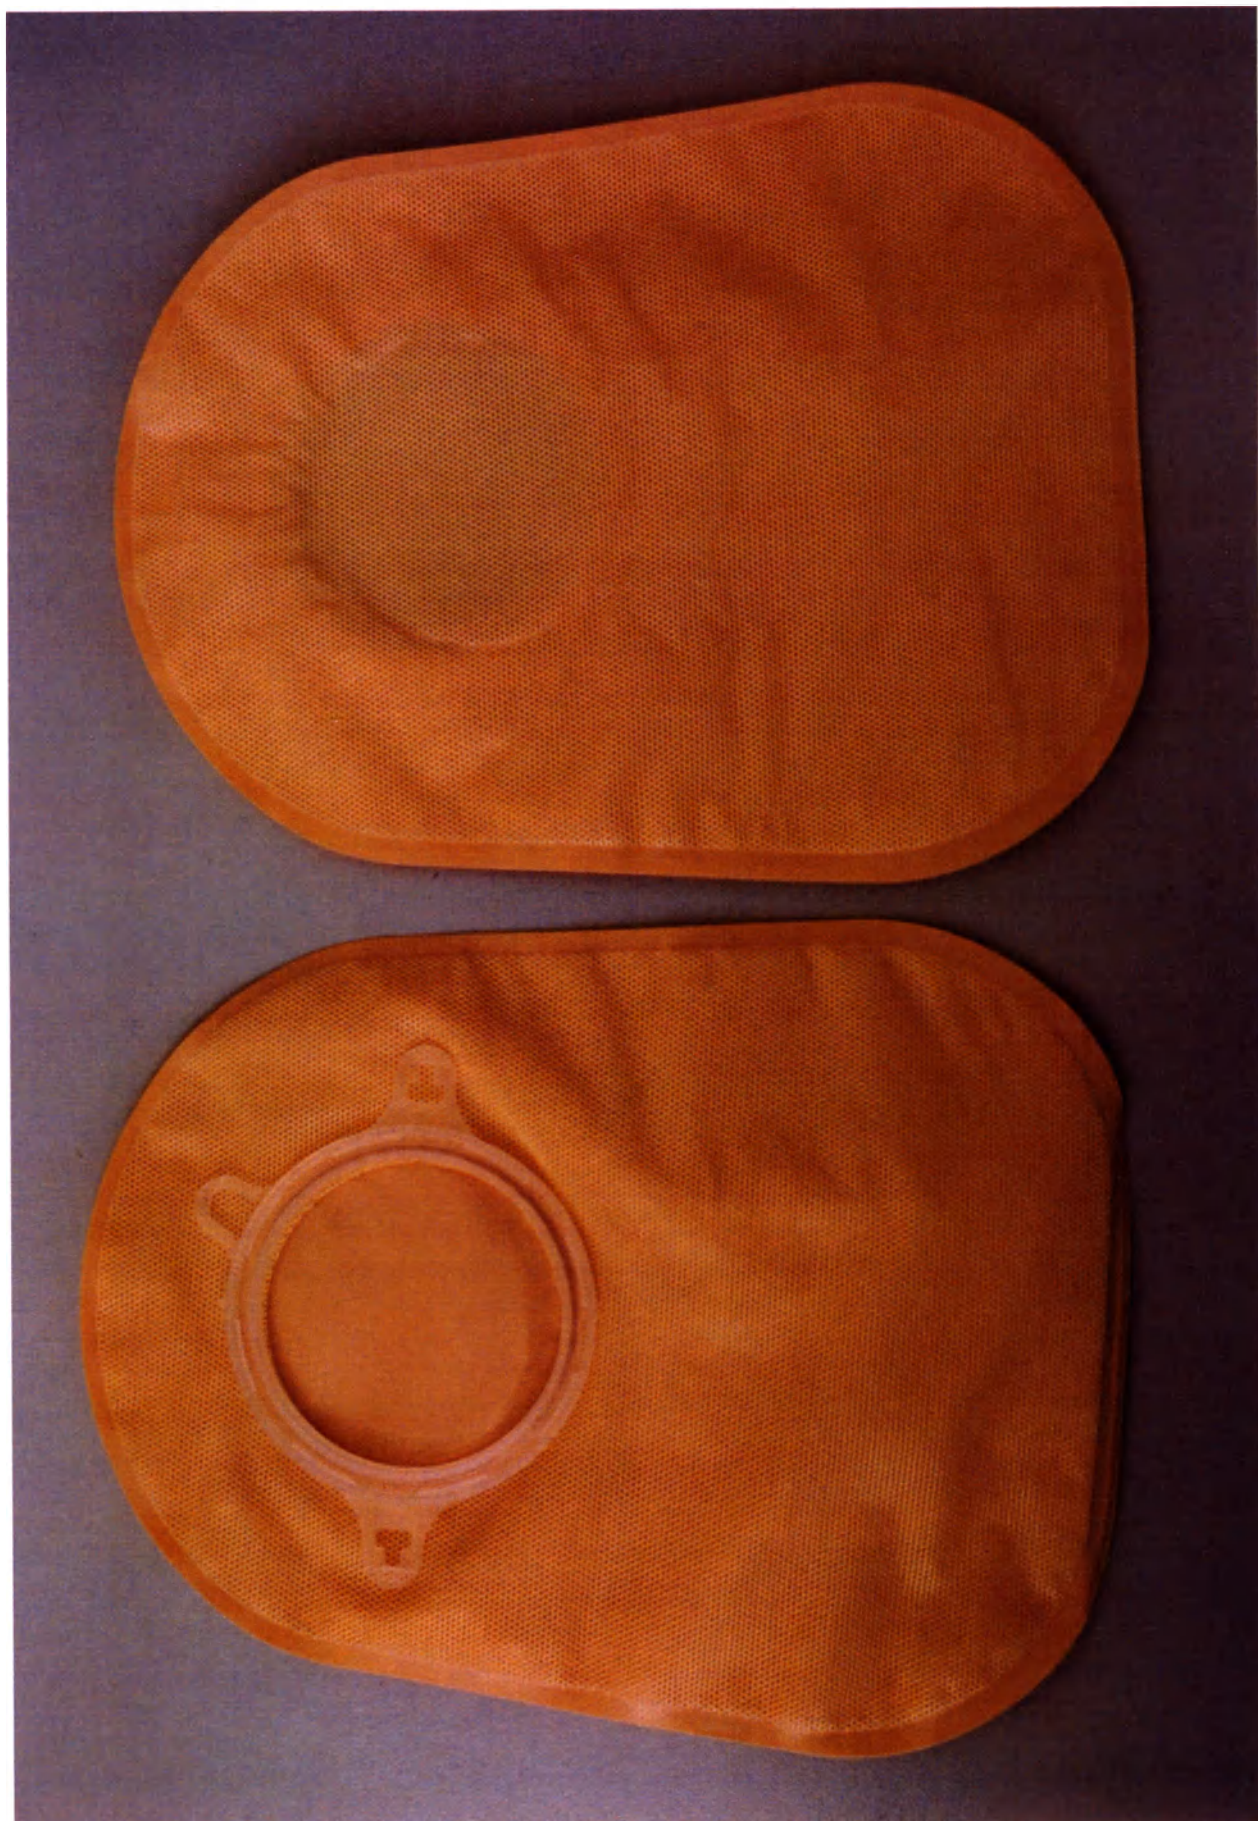


Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.4 Пластина БИНАЦЕЛ®:

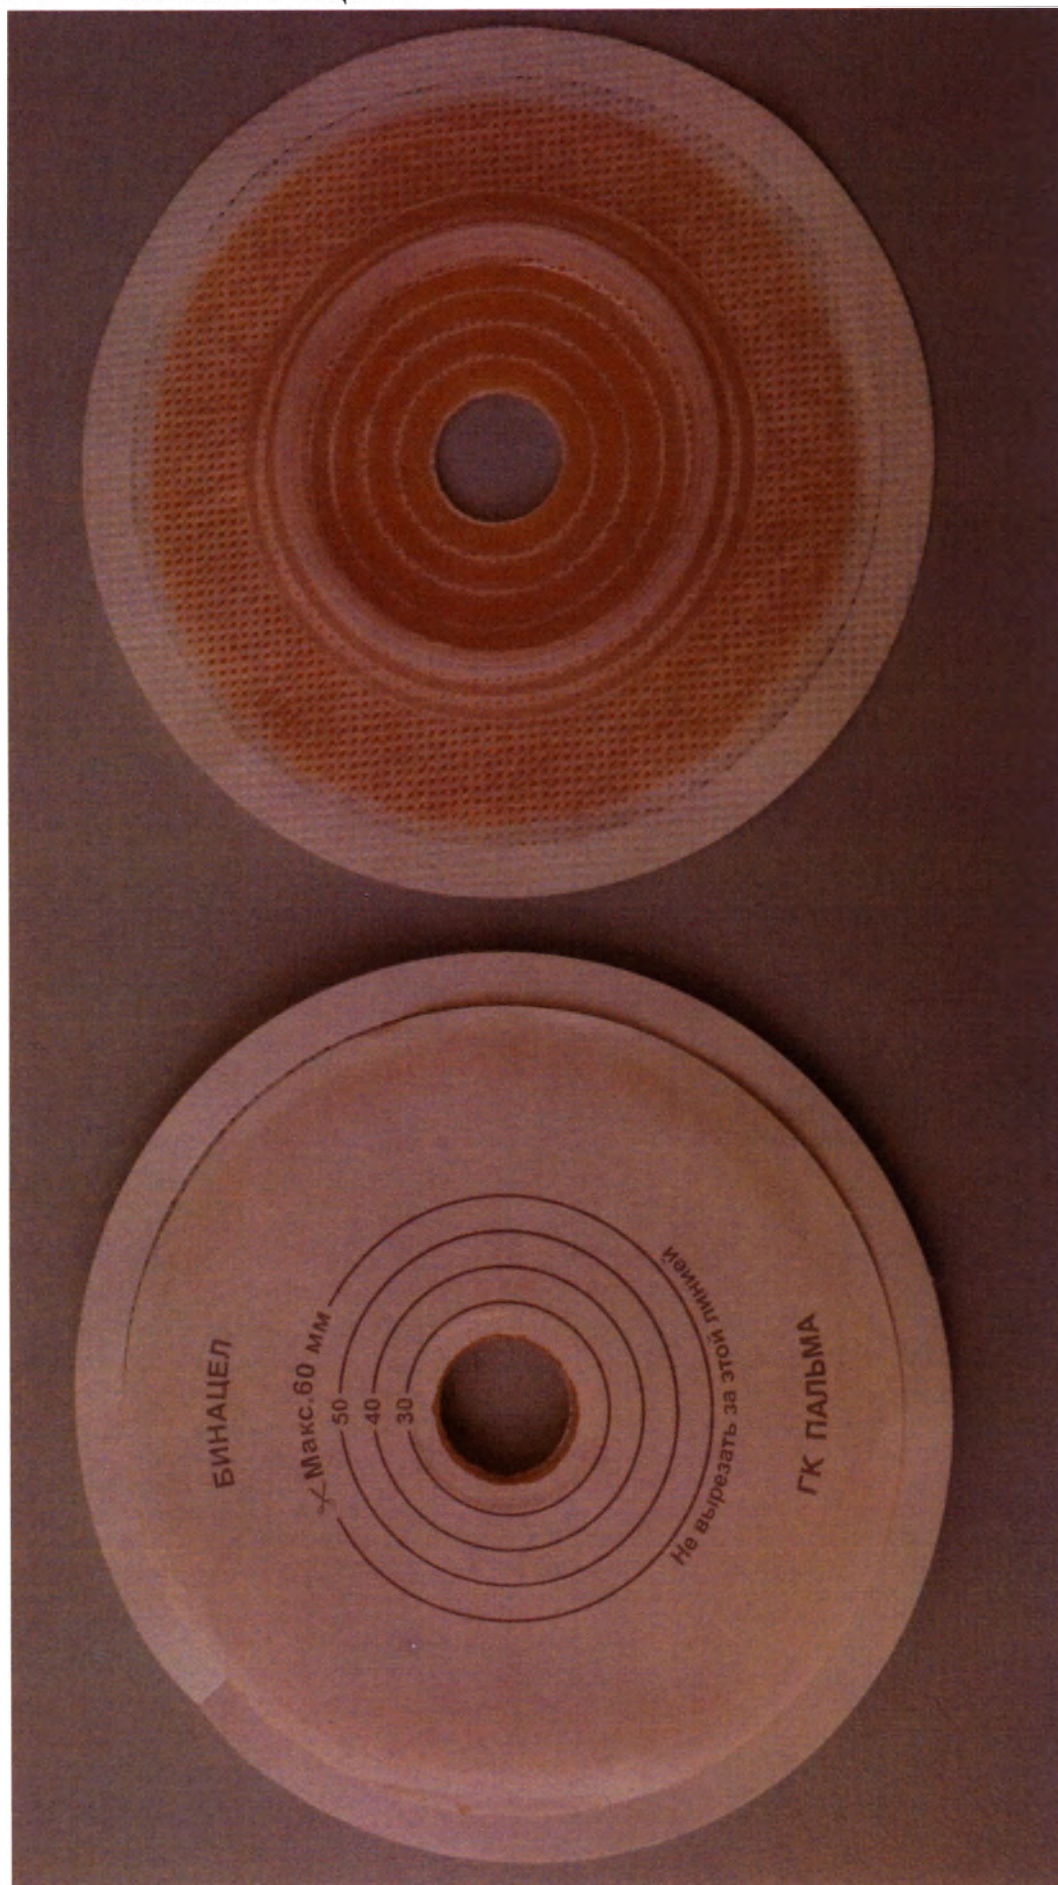


Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.5 Пластина БИНАЦЕЛ®ОПТИМА:

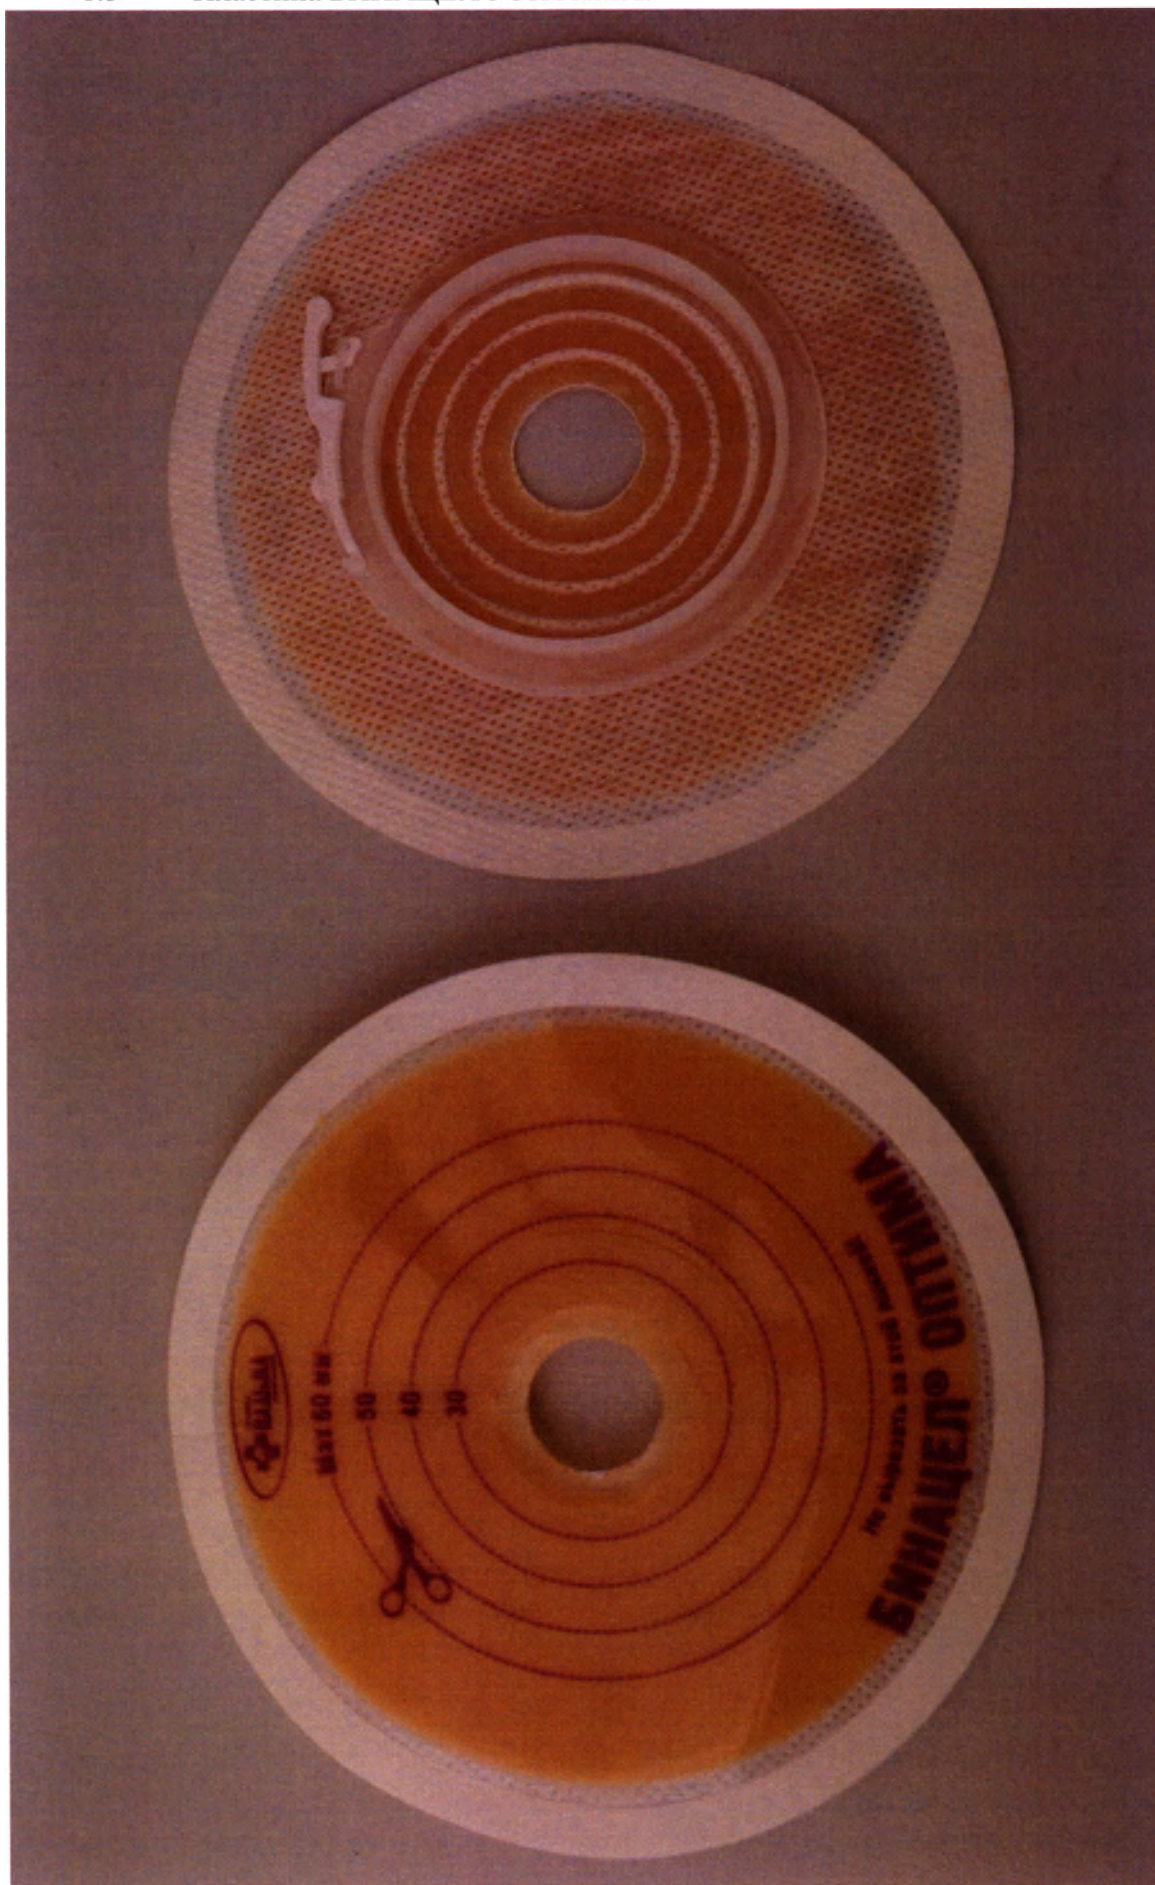

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

1.6 Пластина БИНАЦЕЛ®ПРИМА

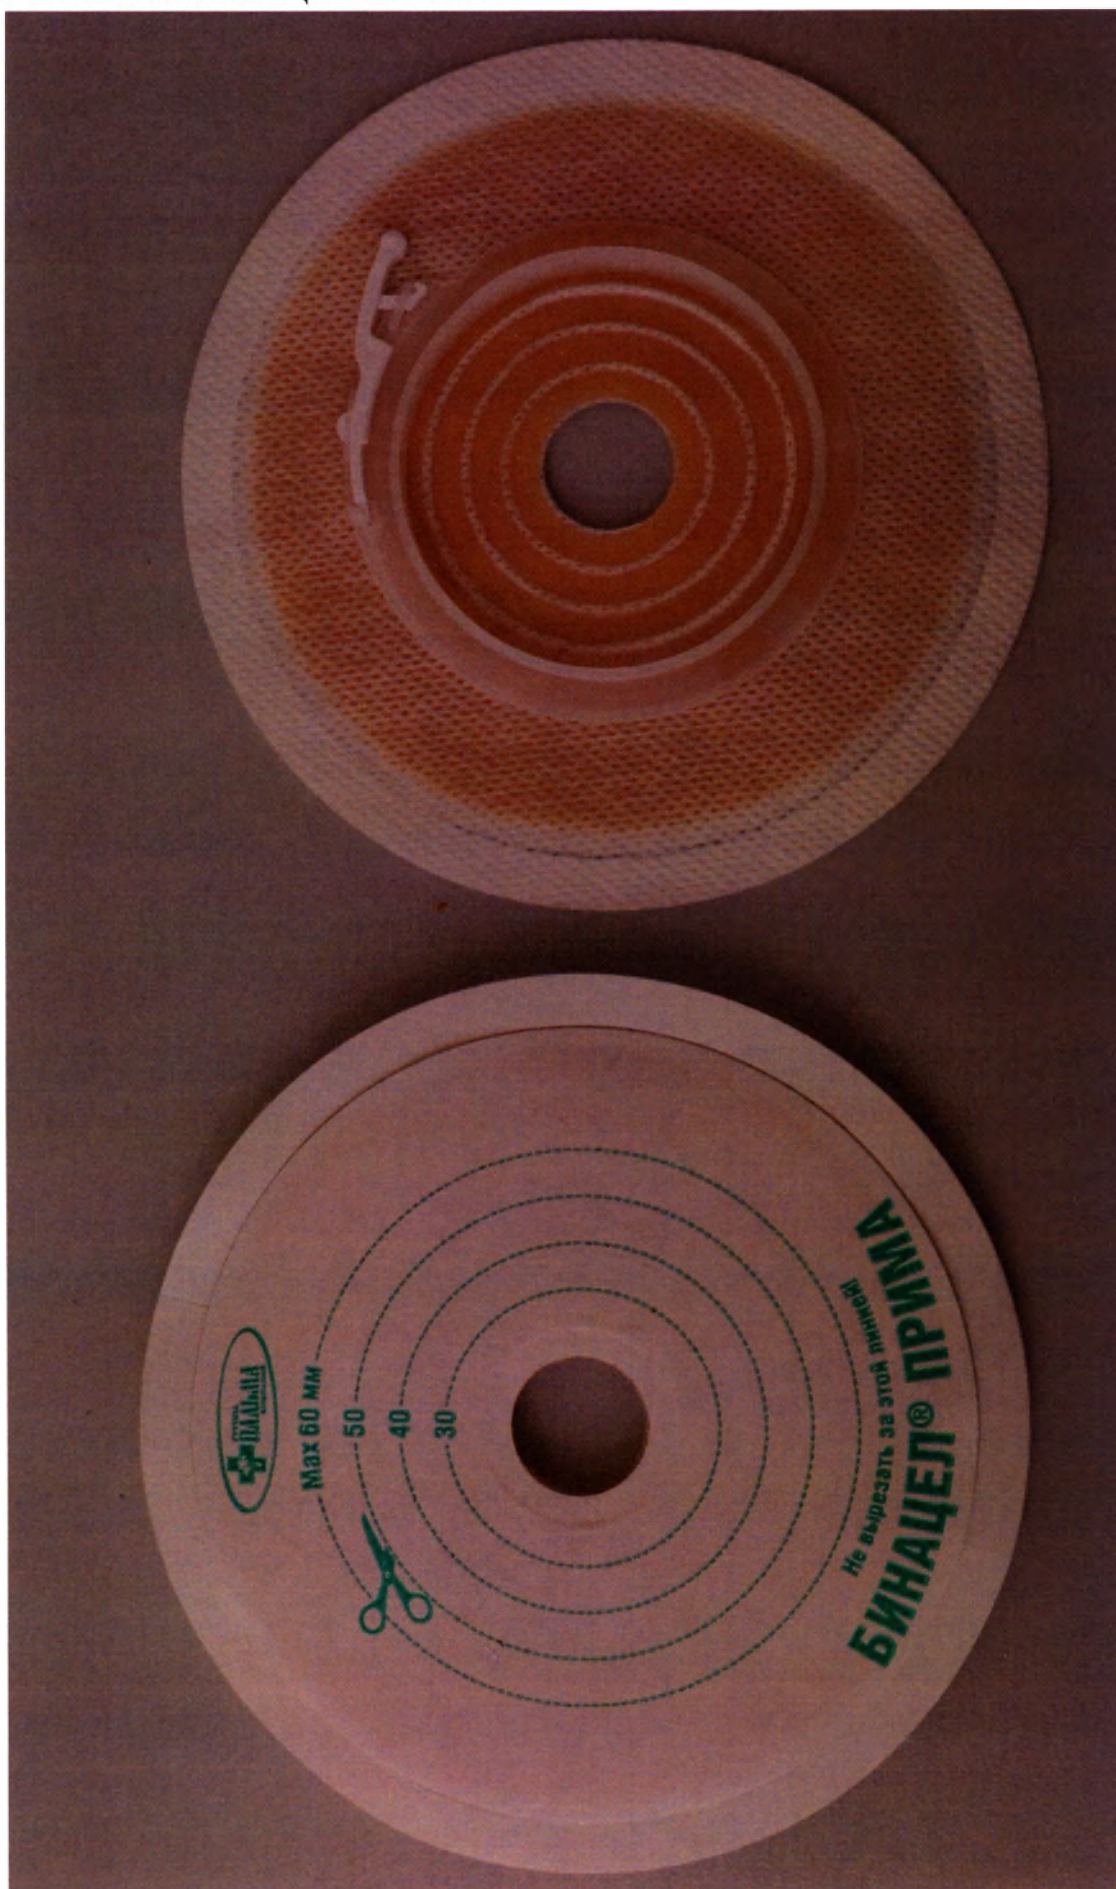

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала


2. Фотографическое изображения общего вида принадлежностей медицинского изделия «Система двухкомпонентная для ухода за стомой БИНАЦЕЛ®-КОЛО по ТУ 32.50.13-012-83228278-2019»:

2.1 Полукольцо СОФАЛЬ, адгезивное:




Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

2.2 Полукольцо СОФАЛЬ А, адгезивное:

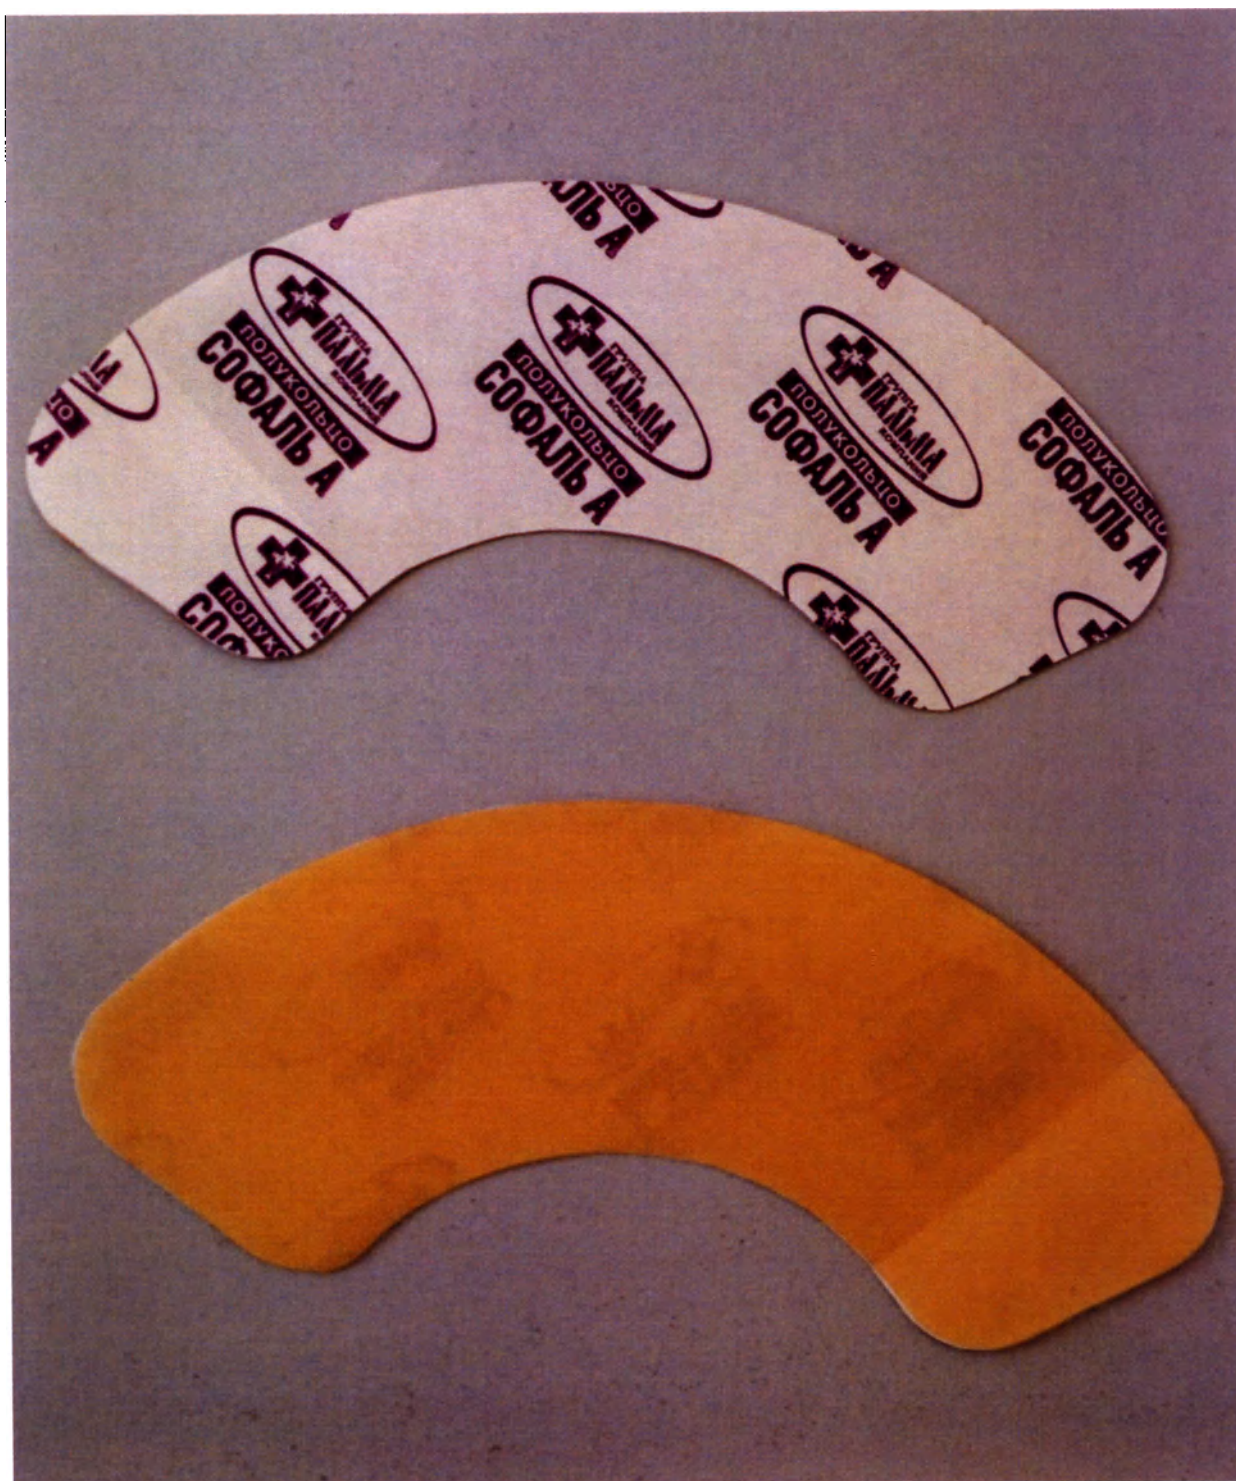

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

2.3 Пояс БИНАЦЕЛ®

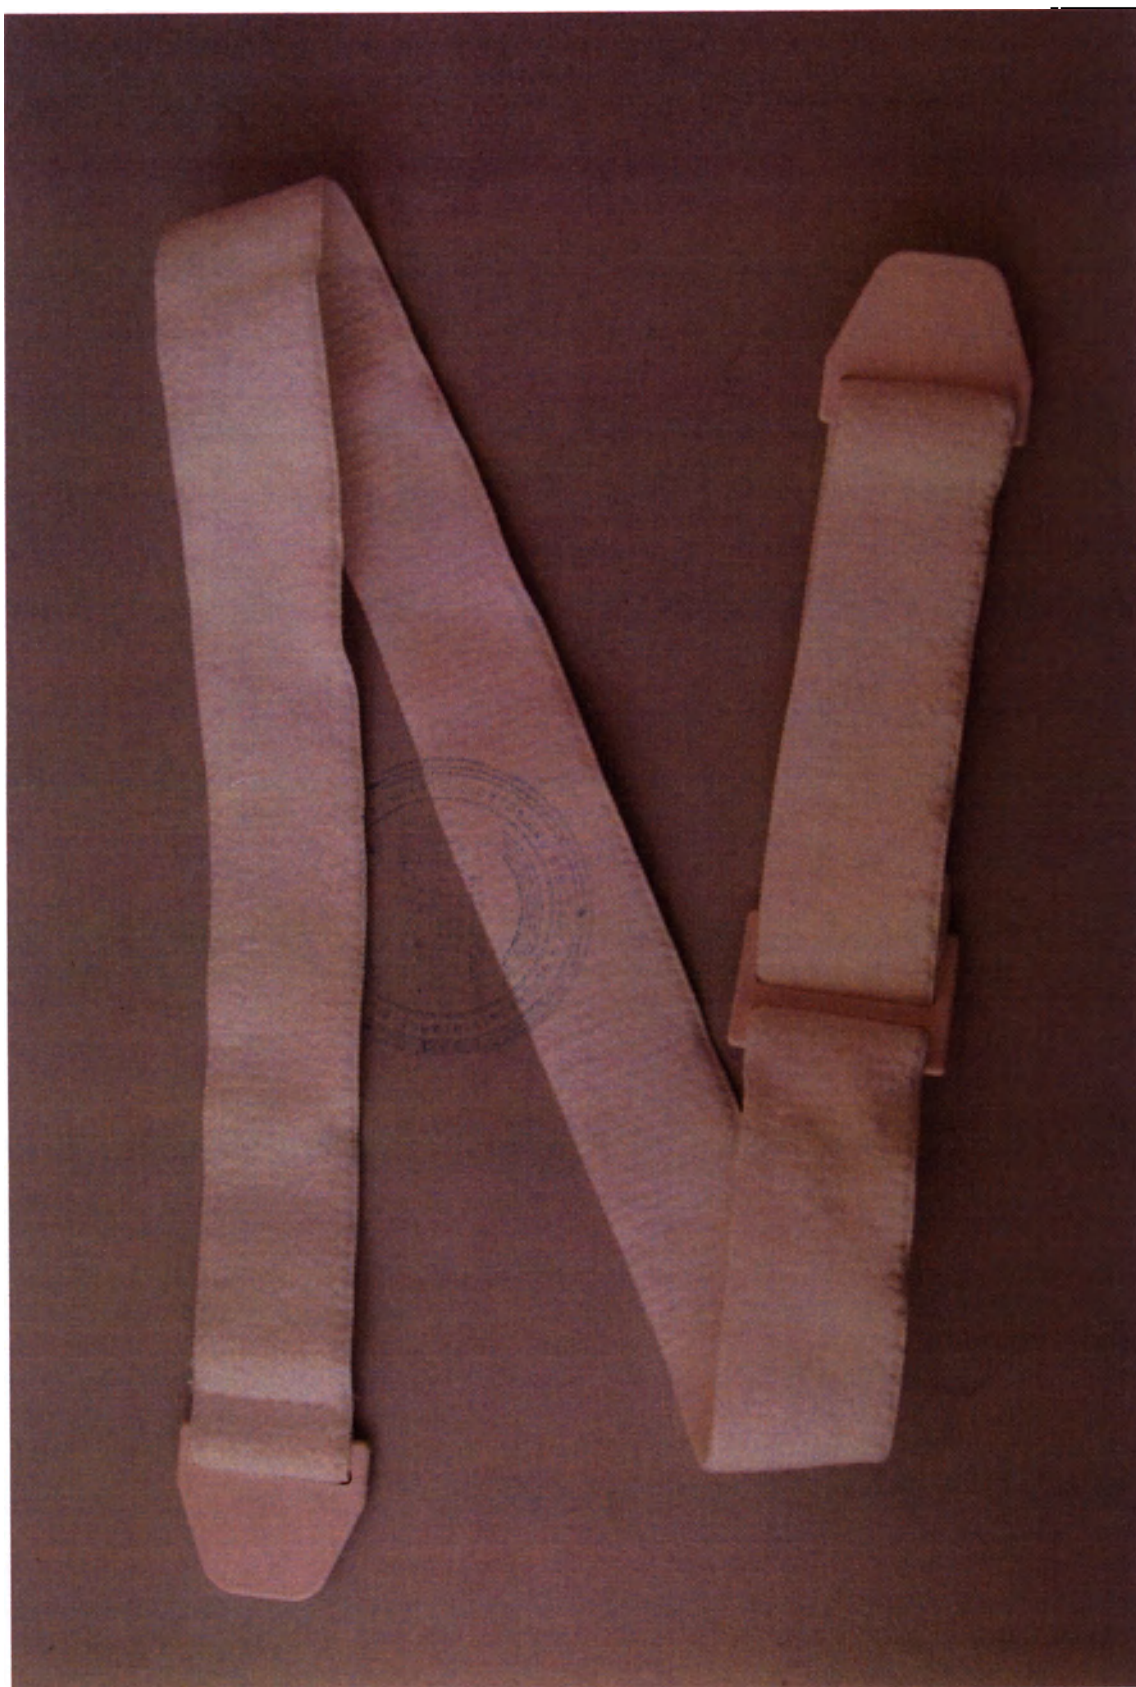

Примечание: размер и цветопередача может отличаться от оригинала

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 10
(десять) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ГК ПАЛЬМА»



Бронштейн Б.Ю.

«21» октября 2024 г.

МП

