



ИНН/КПП 6320073224/632001001
ОГРН 1236300003356
Банковские реквизиты
Р/с 40702.810.5.54400000850
К/с 30101.810.2.00000000607
БИК 043601607 Наименование банка
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ЭКЗО ГРУПП»

Железников В.В.

«12» декабря 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА И МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
АППАРАТ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ - "ЭКЗОТЕРАПИЯ"
ТУ 26.60.13-001-55151370-2024**

2024





Магнитно - волновой стимулятор каркас в сборе




Панель пластиковая боковая




Панель пластиковая




ЖК монитор с системой управления

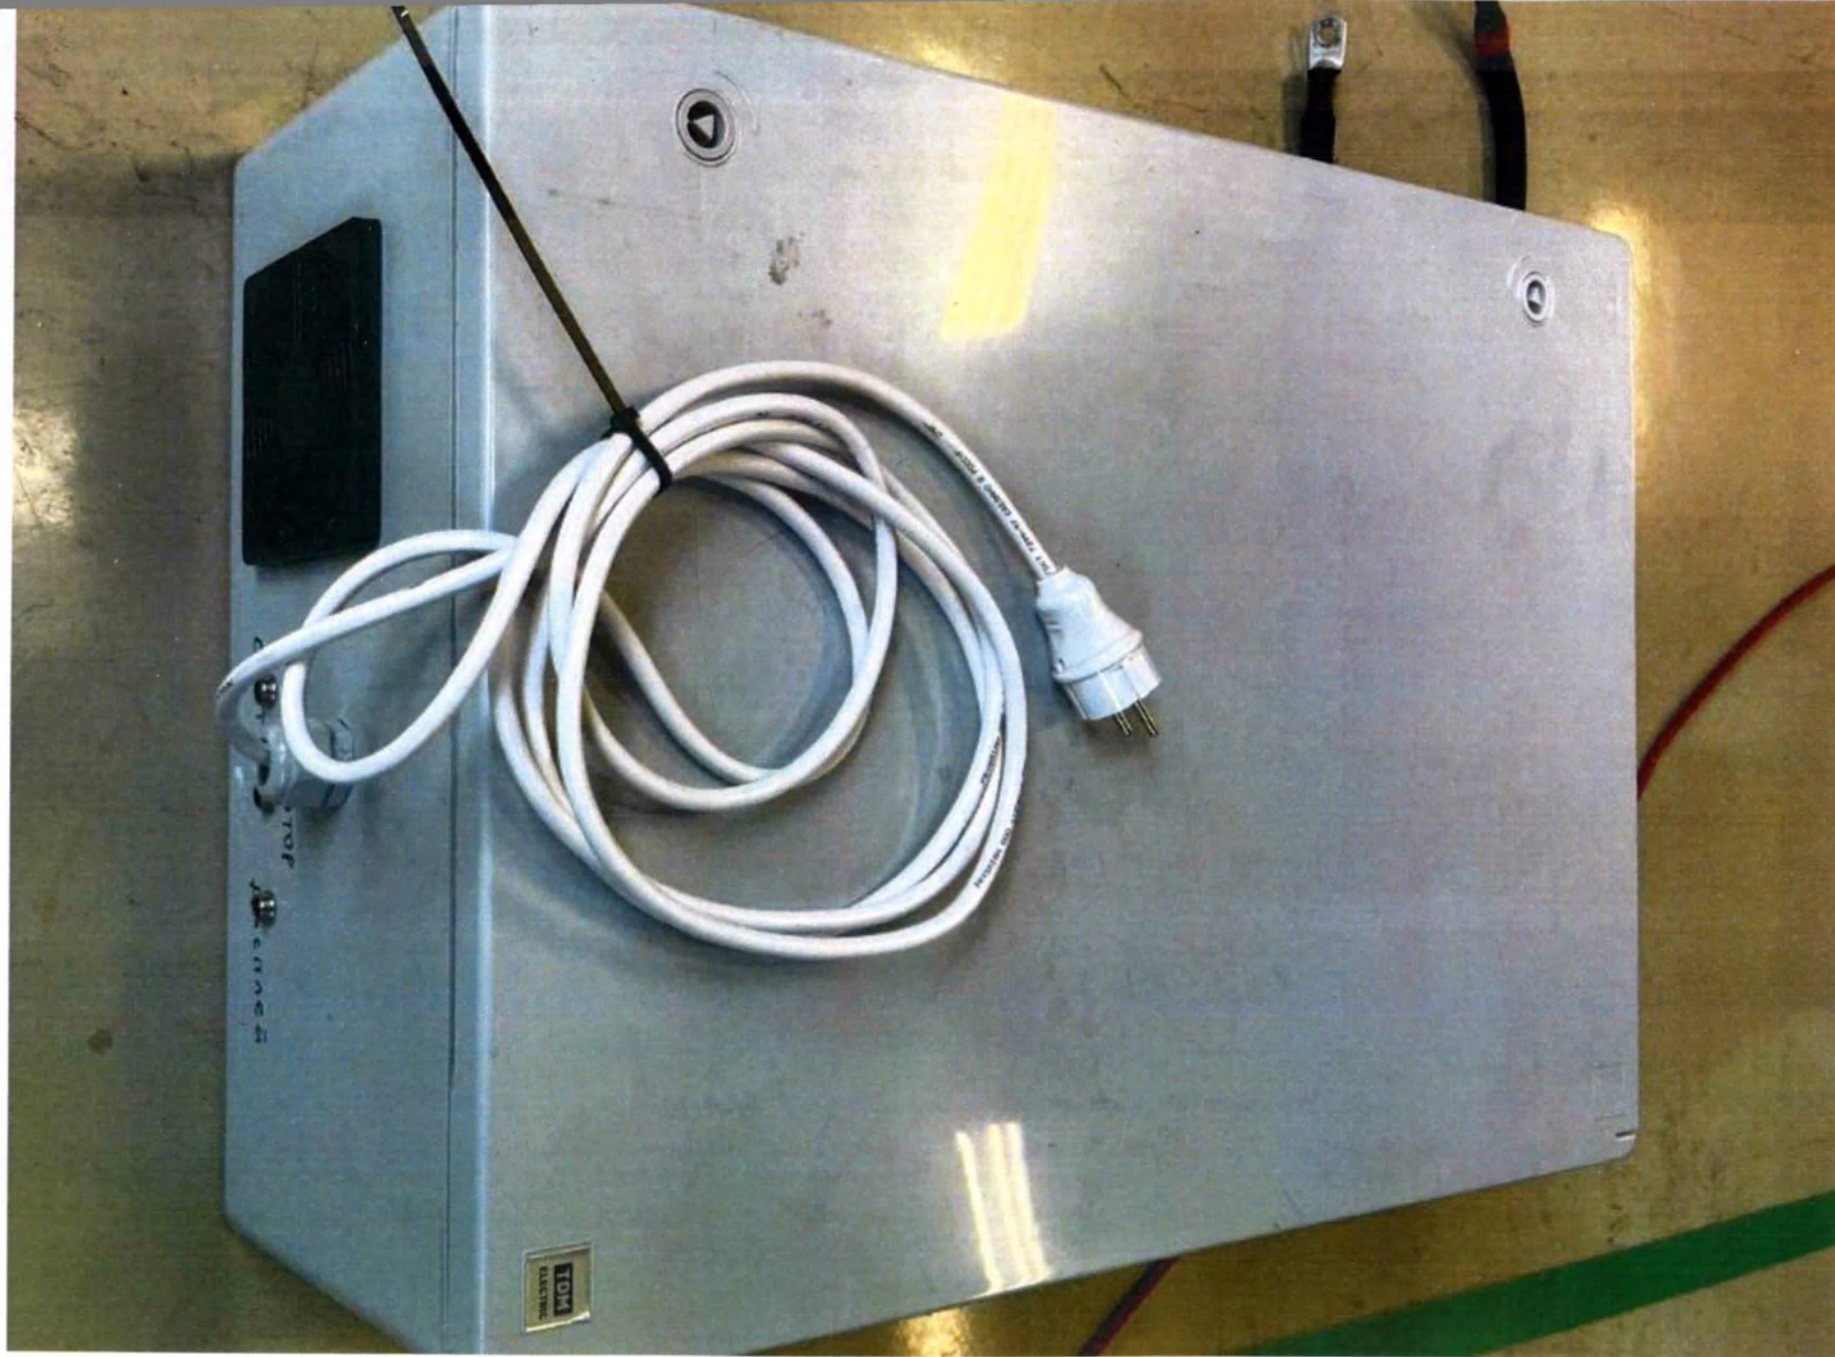

Генератор магнитного импульса напряжением 220В

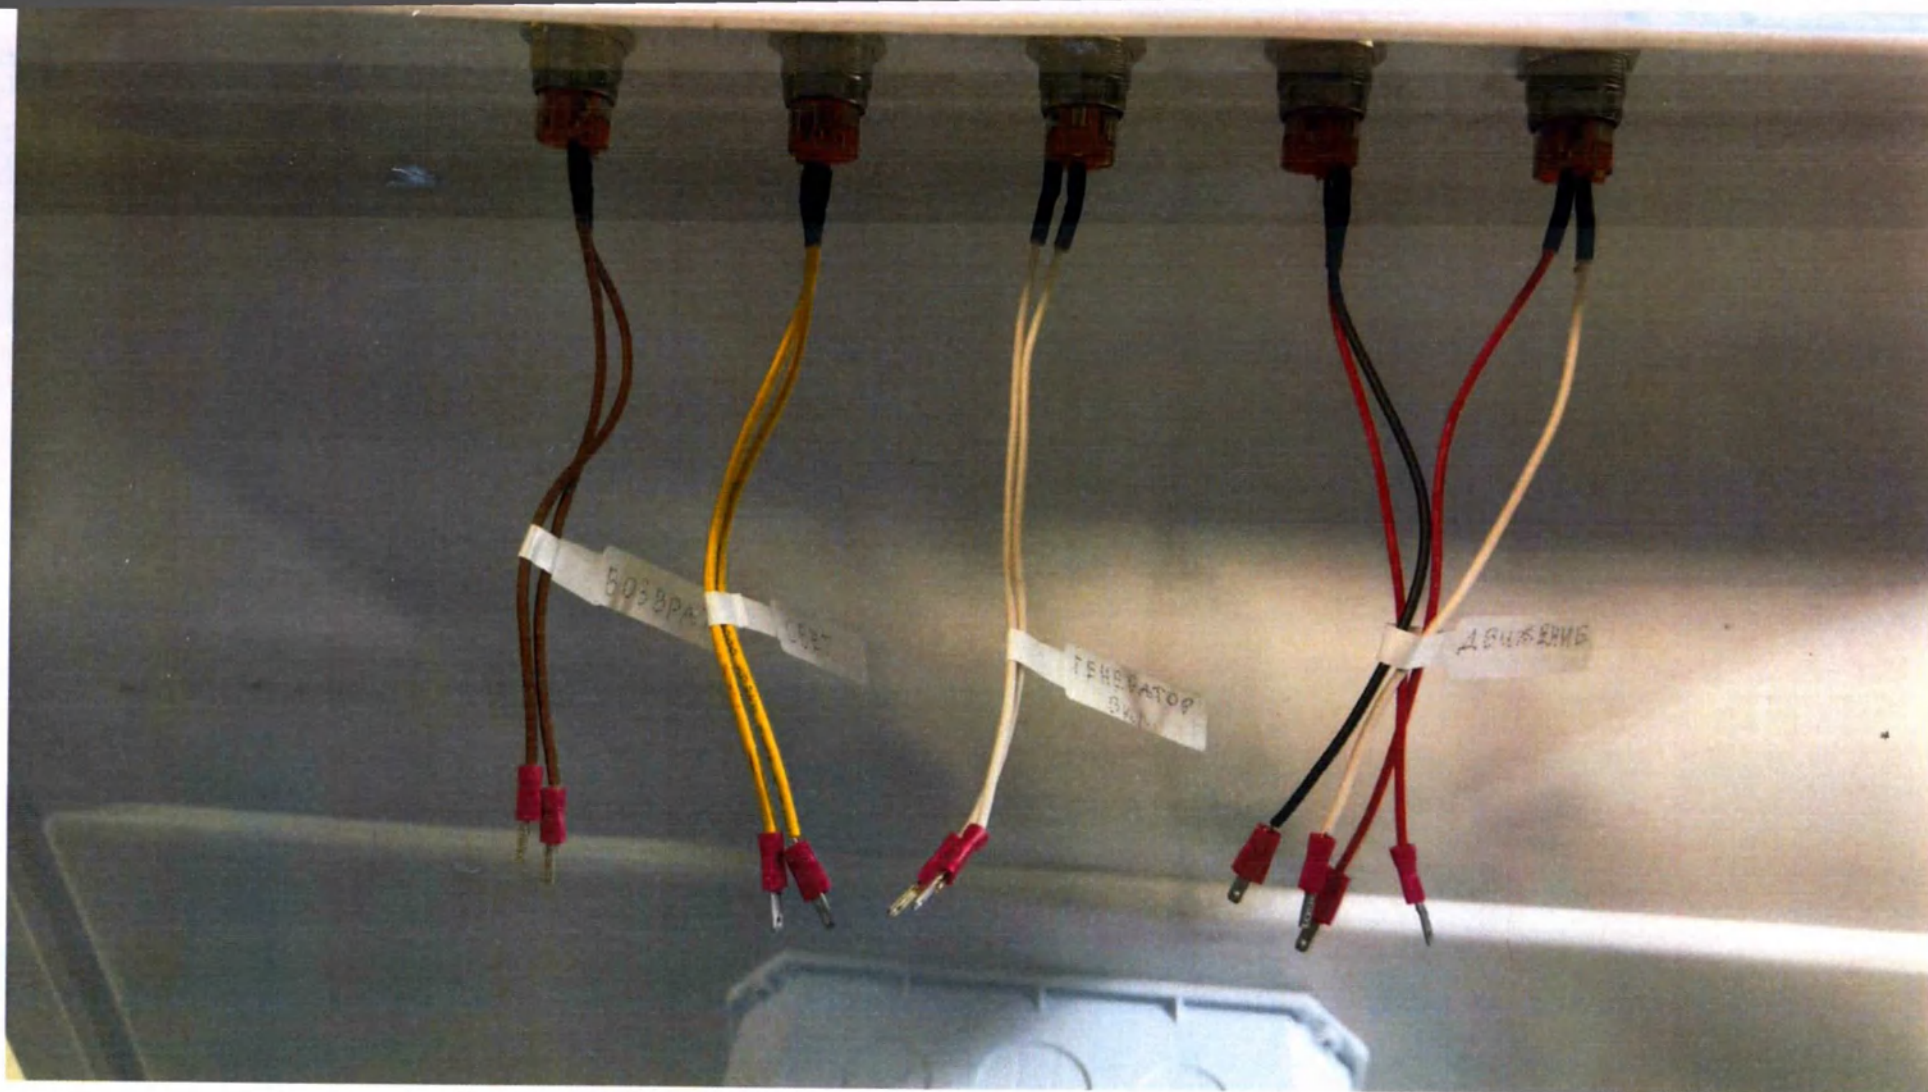

Разъемы Магнитно - волнового стимулятора каркаса в сборе

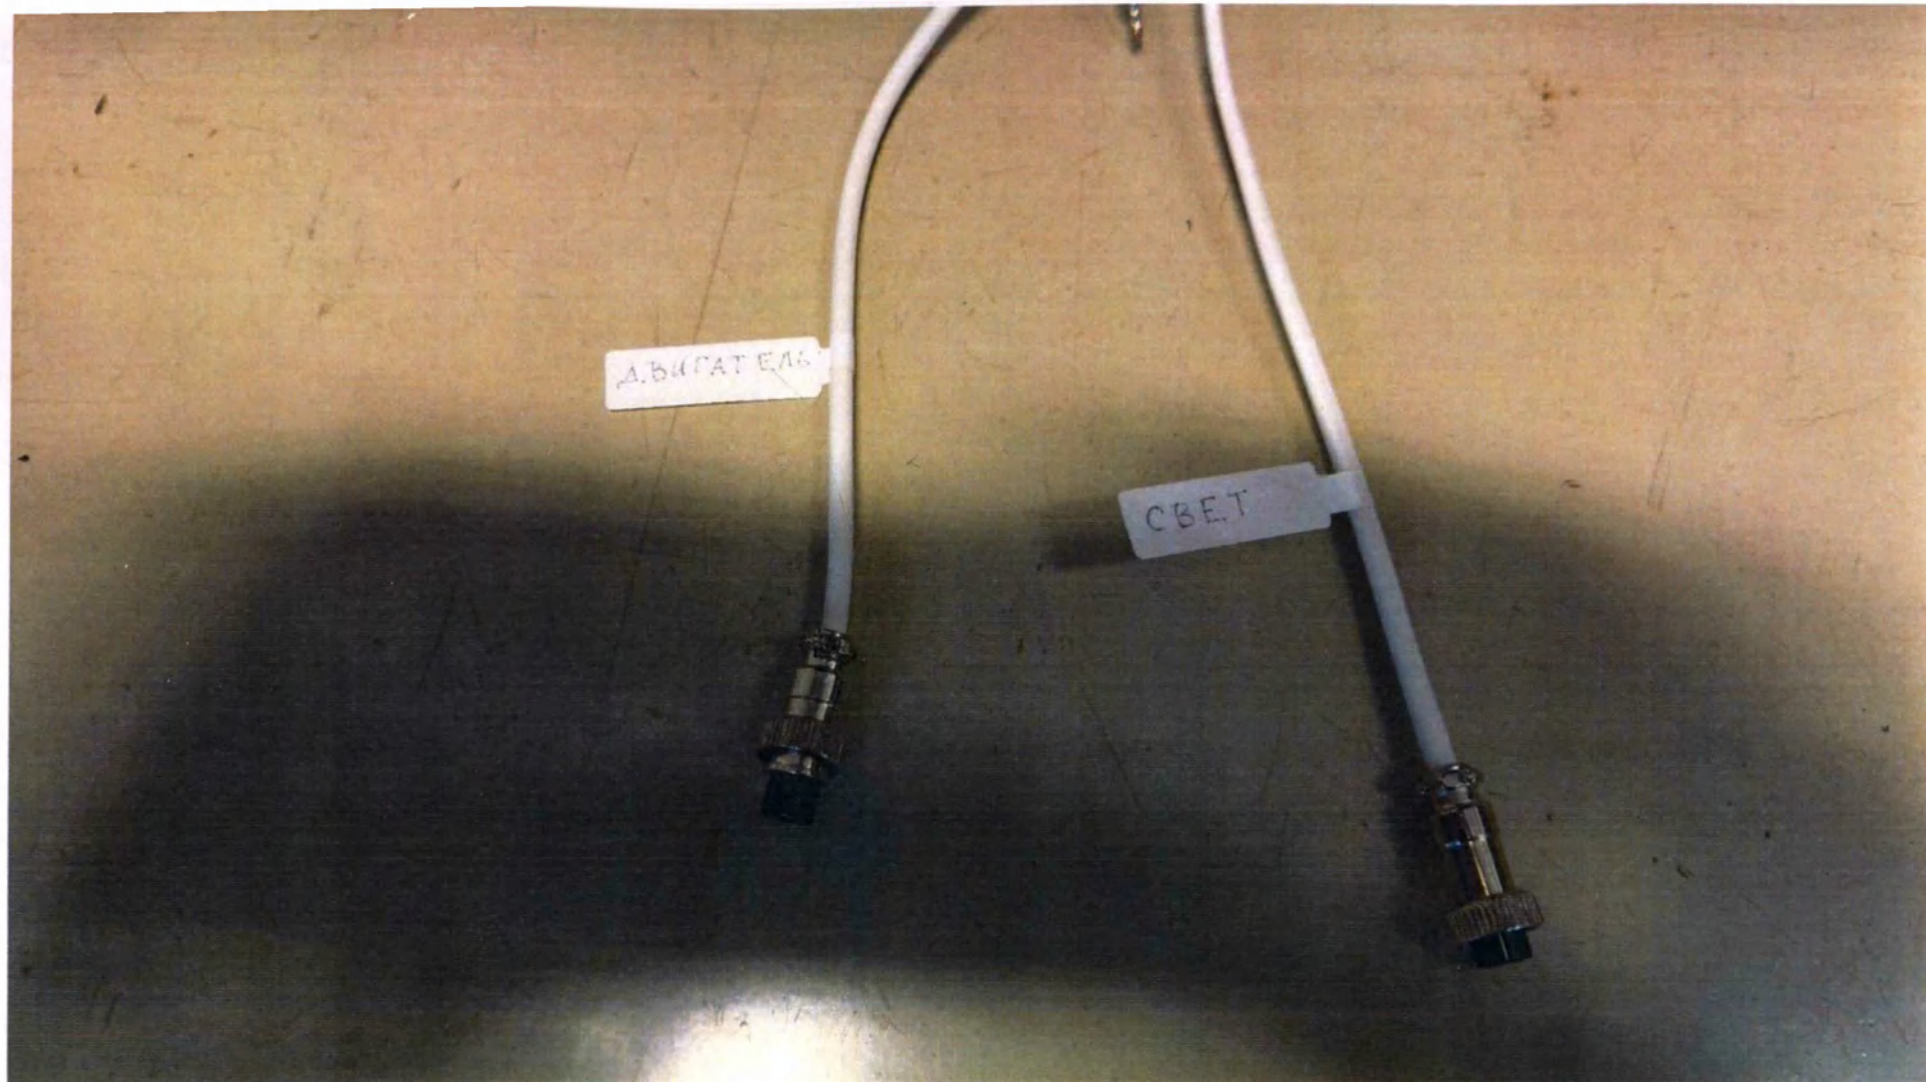

Разъемы Магнитно - волнового стимулятора каркаса в сборе



Разъемы Генератора магнитного импульса напряжением 220В



Разъем ЖК монитора с системой управления



Пульт дистанционного управления







Аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии - "ЭКЗОТЕРАПИЯ"
по ТУ 26.60.13-001-55151370-2024
 Рег.уд. № _____ от _____

 ООО «Экзо Групп»,
 Россия, 445043, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. южное, Зд. 163А, ком. 34

Серийный номер: 2023 - 0023
 Номинальное напряжение: ~ 220 В
 Частота тока: 50Hz
 Потребляемая мощность: ≤ 12А
 Номинальная выходная мощность: 30 920 Вт
 Сопротивление нагрузки: 0.01 Ом
 Рабочая частота: 0,001666 МГц
 Режим работы: 20мин. работа - 15мин. перерыв.
 Дата производства: 04.2023

ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!





IP20






Макет маркировки транспортного модуля медицинского изделия: Аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии - "ЭкзоТерапия"

Аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии - "ЭКЗОТЕРАПИЯ"
по ТУ 26.60.13-001-55151370-2024
 Рег.уд. № _____ от _____

 ООО «Экзо Групп»,
 Россия, 445043, Самарская область, г. о. Тольятти, г. Тольятти, ш. южное, Зд. 163А, ком. 34

Состав:

1. Стенд высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии - "ЭкзоТерапия" - 1, в составе:
 1. Магнитно - волновой стимулятор каркас в сборе - 1шт.;
 2. Панель пластиковая - 2 шт.;
 3. Панель пластиковая боковая - 2шт.;
 4. ЖК монитор с системой управления DWIN артикул: DMG10600T101_A5WTC – 1 шт.;
 5. Генератор магнитного импульса, напряжением 220 В – 1 шт.;
 6. Пульт дистанционного управления в составе:
 - Пульт дистанционного управления в составе – 1 шт.;
 - Батарейка CR 2032 (при необходимости) - 1 шт.;
 7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Брутто 211 кг.
 Нетто 320 кг.









Маркировка ЖК монитор с системой управления



Маркировка Пульт дистанционного управления



Маркировка Генератор магнитного импульса

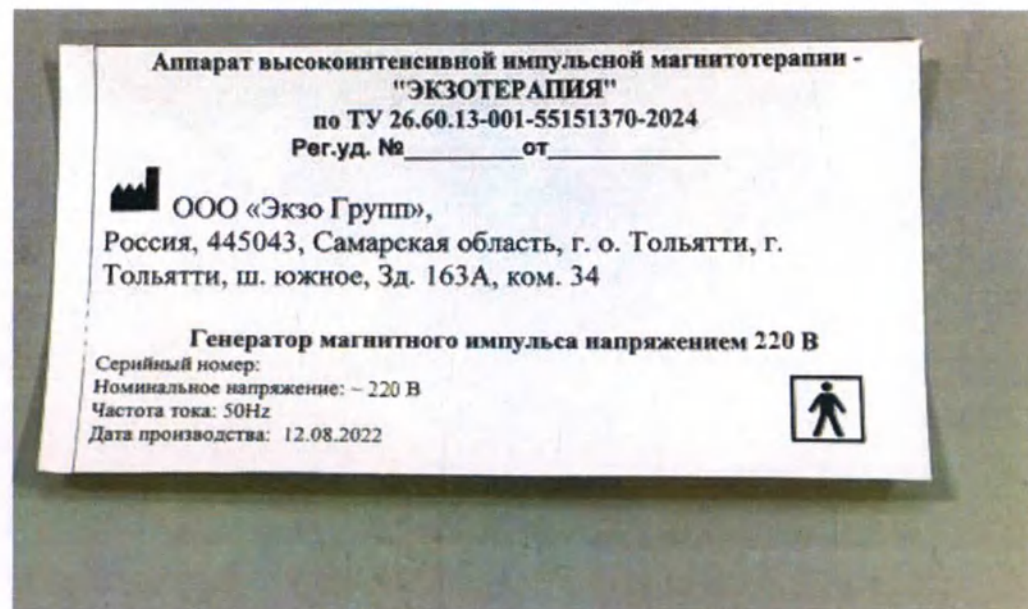

Всего прошито пронумеровано и скреплено
печатью 18 (Восемнадцать)
листа(ов).

