


Фотографические изображения
медицинского изделия

**Томограф магнитно-резонансный *SIGNA*,
с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации и
сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

 А.П.Харитоновна

« 30 » ноября 2021г



Производства

«ДжиИ Хэлскеа (Тяньцзинь) Компани Лимитед»,
Китай

GE Healthcare (Tianjin) Company Limited



GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.
NO. 266 JINGSAN ROAD
TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308

REF

6433265-1: SIGNA Creator

SN



1: 73A/200V3~, 50/60Hz
2: 70A/208V3~, 50/60Hz
3: 38A/380V3~, 50/60Hz
4: 37A/400V3~, 50/60Hz
5: 35A/415V3~, 50/60Hz
6: 31A/480V3~, 50/60Hz



MADE FOR



GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.
NO. 266 JINGSAN ROAD
TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308

ASSEMBLED IN US

GE Healthcare Manufacturing LLC
3001 West Radio Drive
Florence, SC 29501 USA

REF

6433265-1: SIGNA Creator

SN



1: 73A/200V3~, 50/60Hz 4: 37A/400V3~, 50/60Hz
2: 70A/208V3~, 50/60Hz 5: 35A/415V3~, 50/60Hz
3: 38A/380V3~, 50/60Hz 6: 31A/480V3~, 50/60Hz



GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.
NO. 266 JINGSAN ROAD
TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308



GE Healthcare Manufacturing LLC
3001 West Radio Drive
Florence, SC 29501 USA



6433265-1: SIGNA Creator



1: 73A/200V3~, 50/60Hz	4: 37A/400V3~, 50/60Hz
2: 70A/208V3~, 50/60Hz	5: 35A/415V3~, 50/60Hz
3: 38A/380V3~, 50/60Hz	6: 31A/480V3~, 50/60Hz

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»
для GE Healthcare (Tianjin) Company Limited

Томограф магнитно-резонансный SIGNA Creator

REF XXXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXXX

 XX.XX.XXXX


EAC




38 A, 380 В 3 ~, 50 Гц,
37 A, 400 В 3 ~, 50 Гц,
35 A, 415 В 3 ~, 50 Гц

Сделано в России


XXXXXXXX

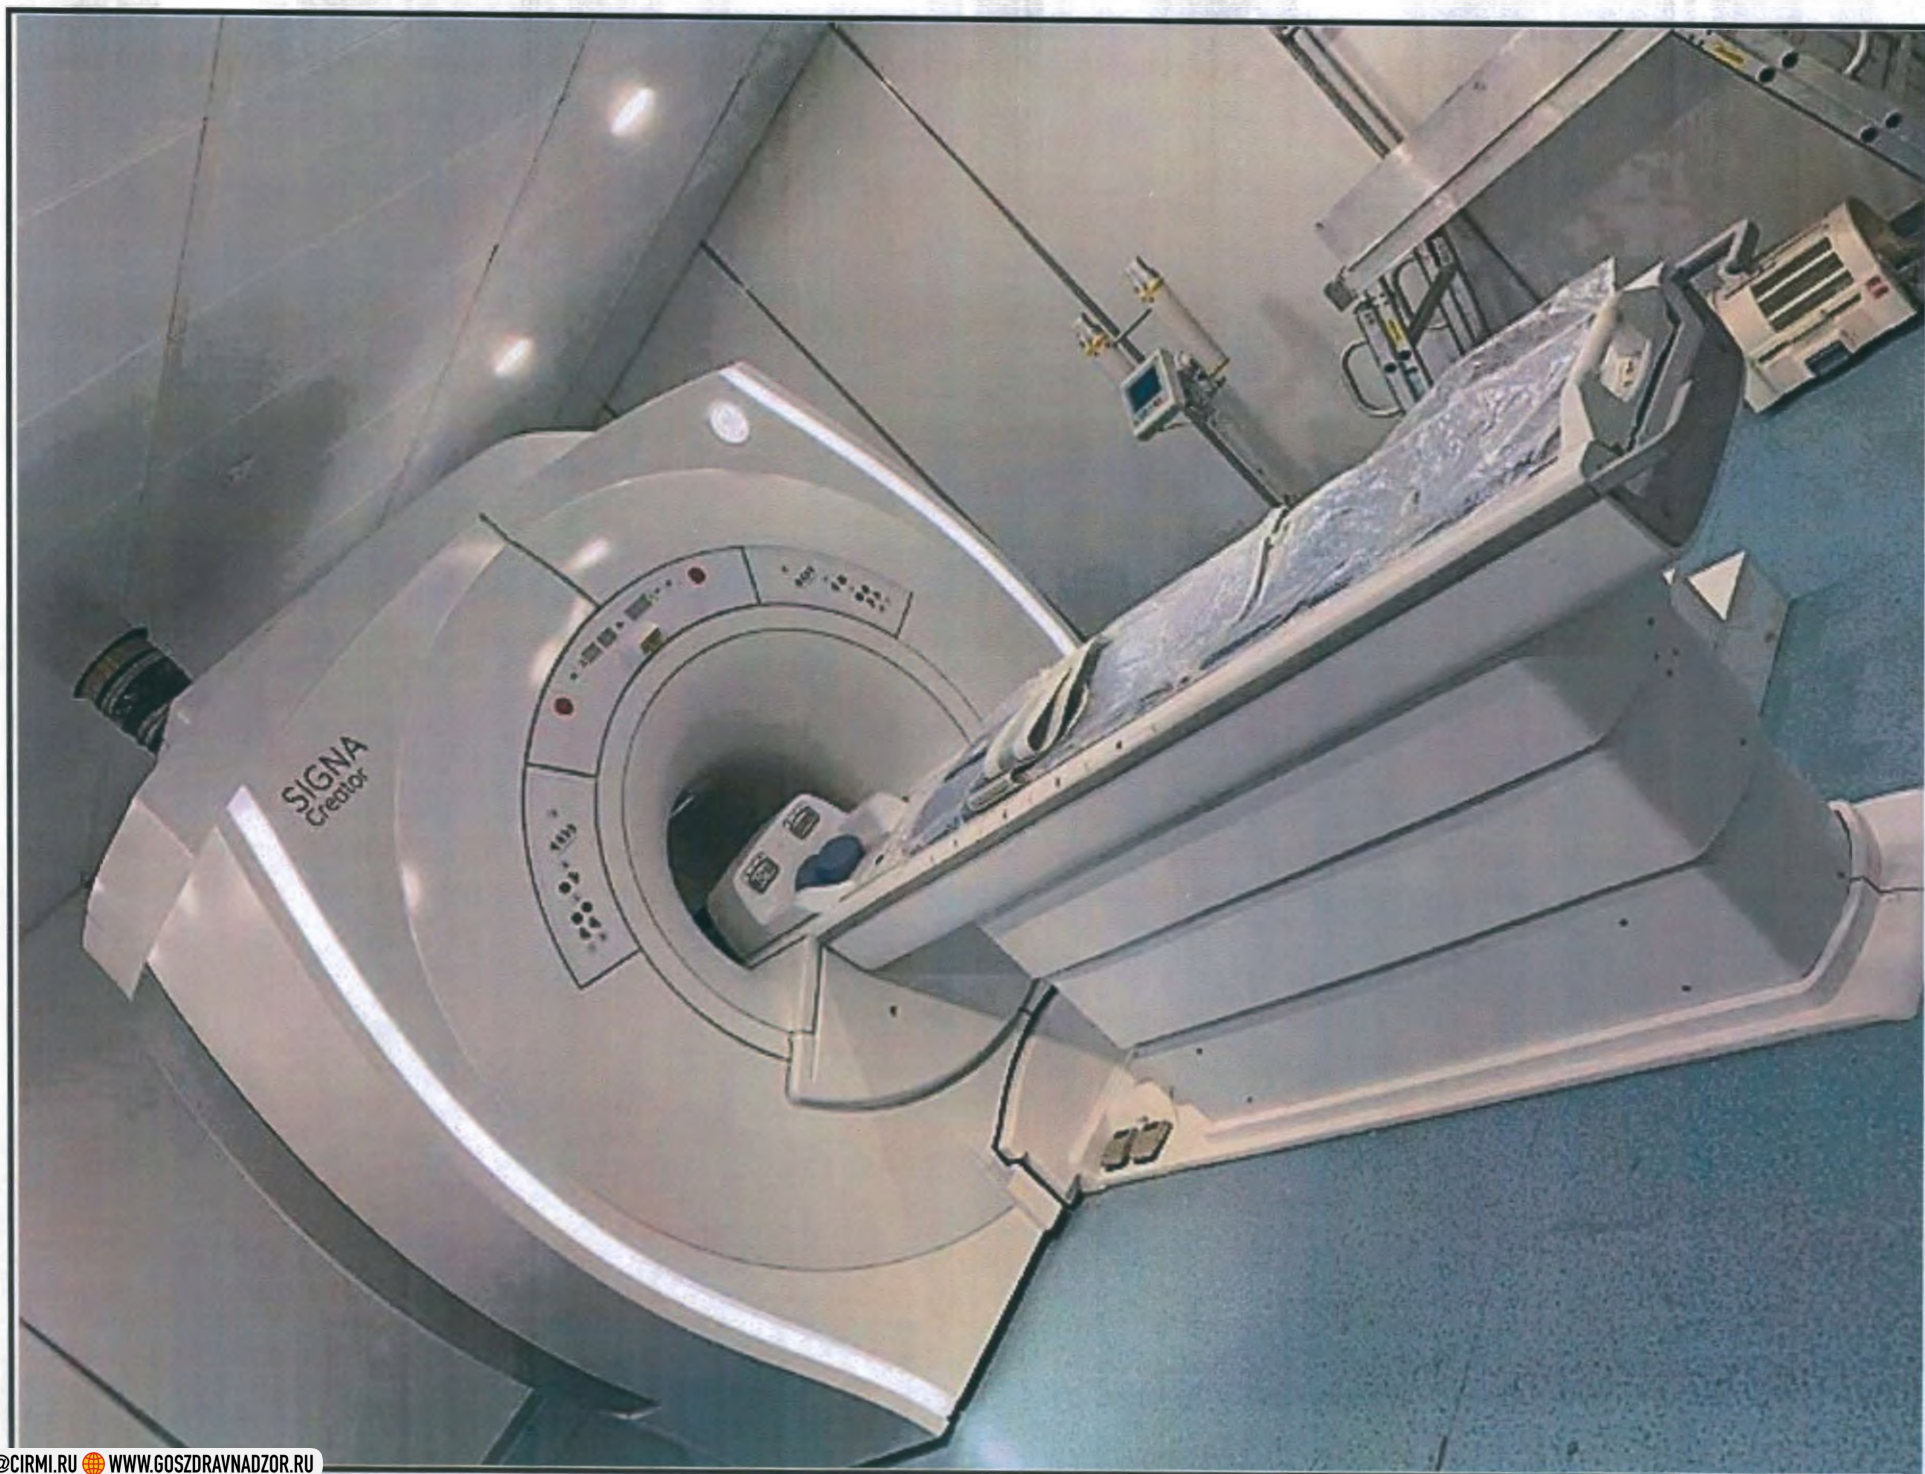


1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

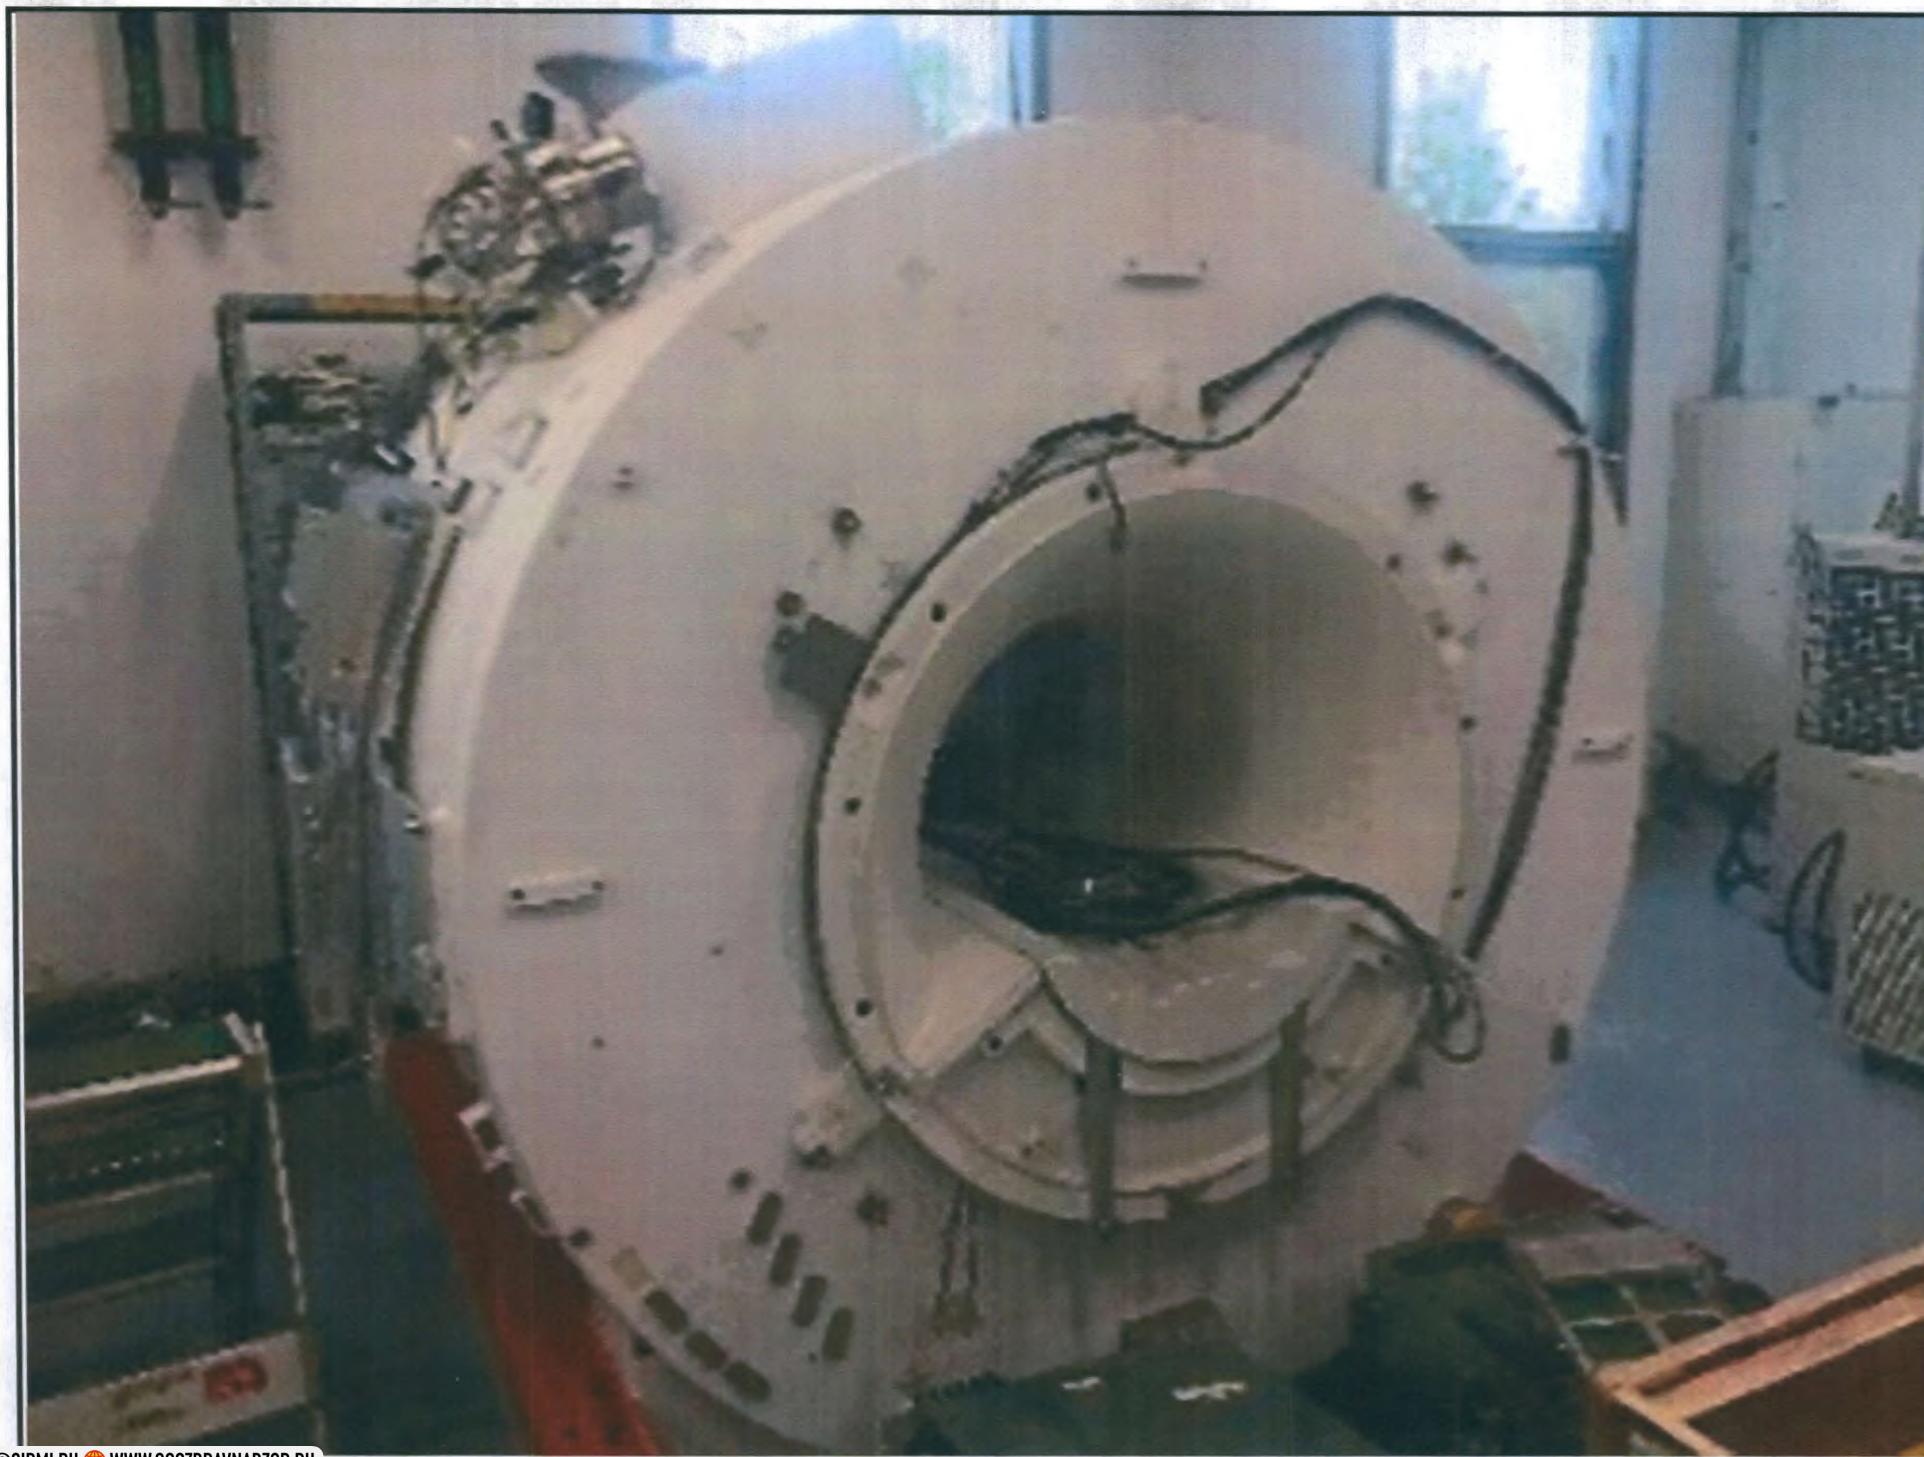

1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

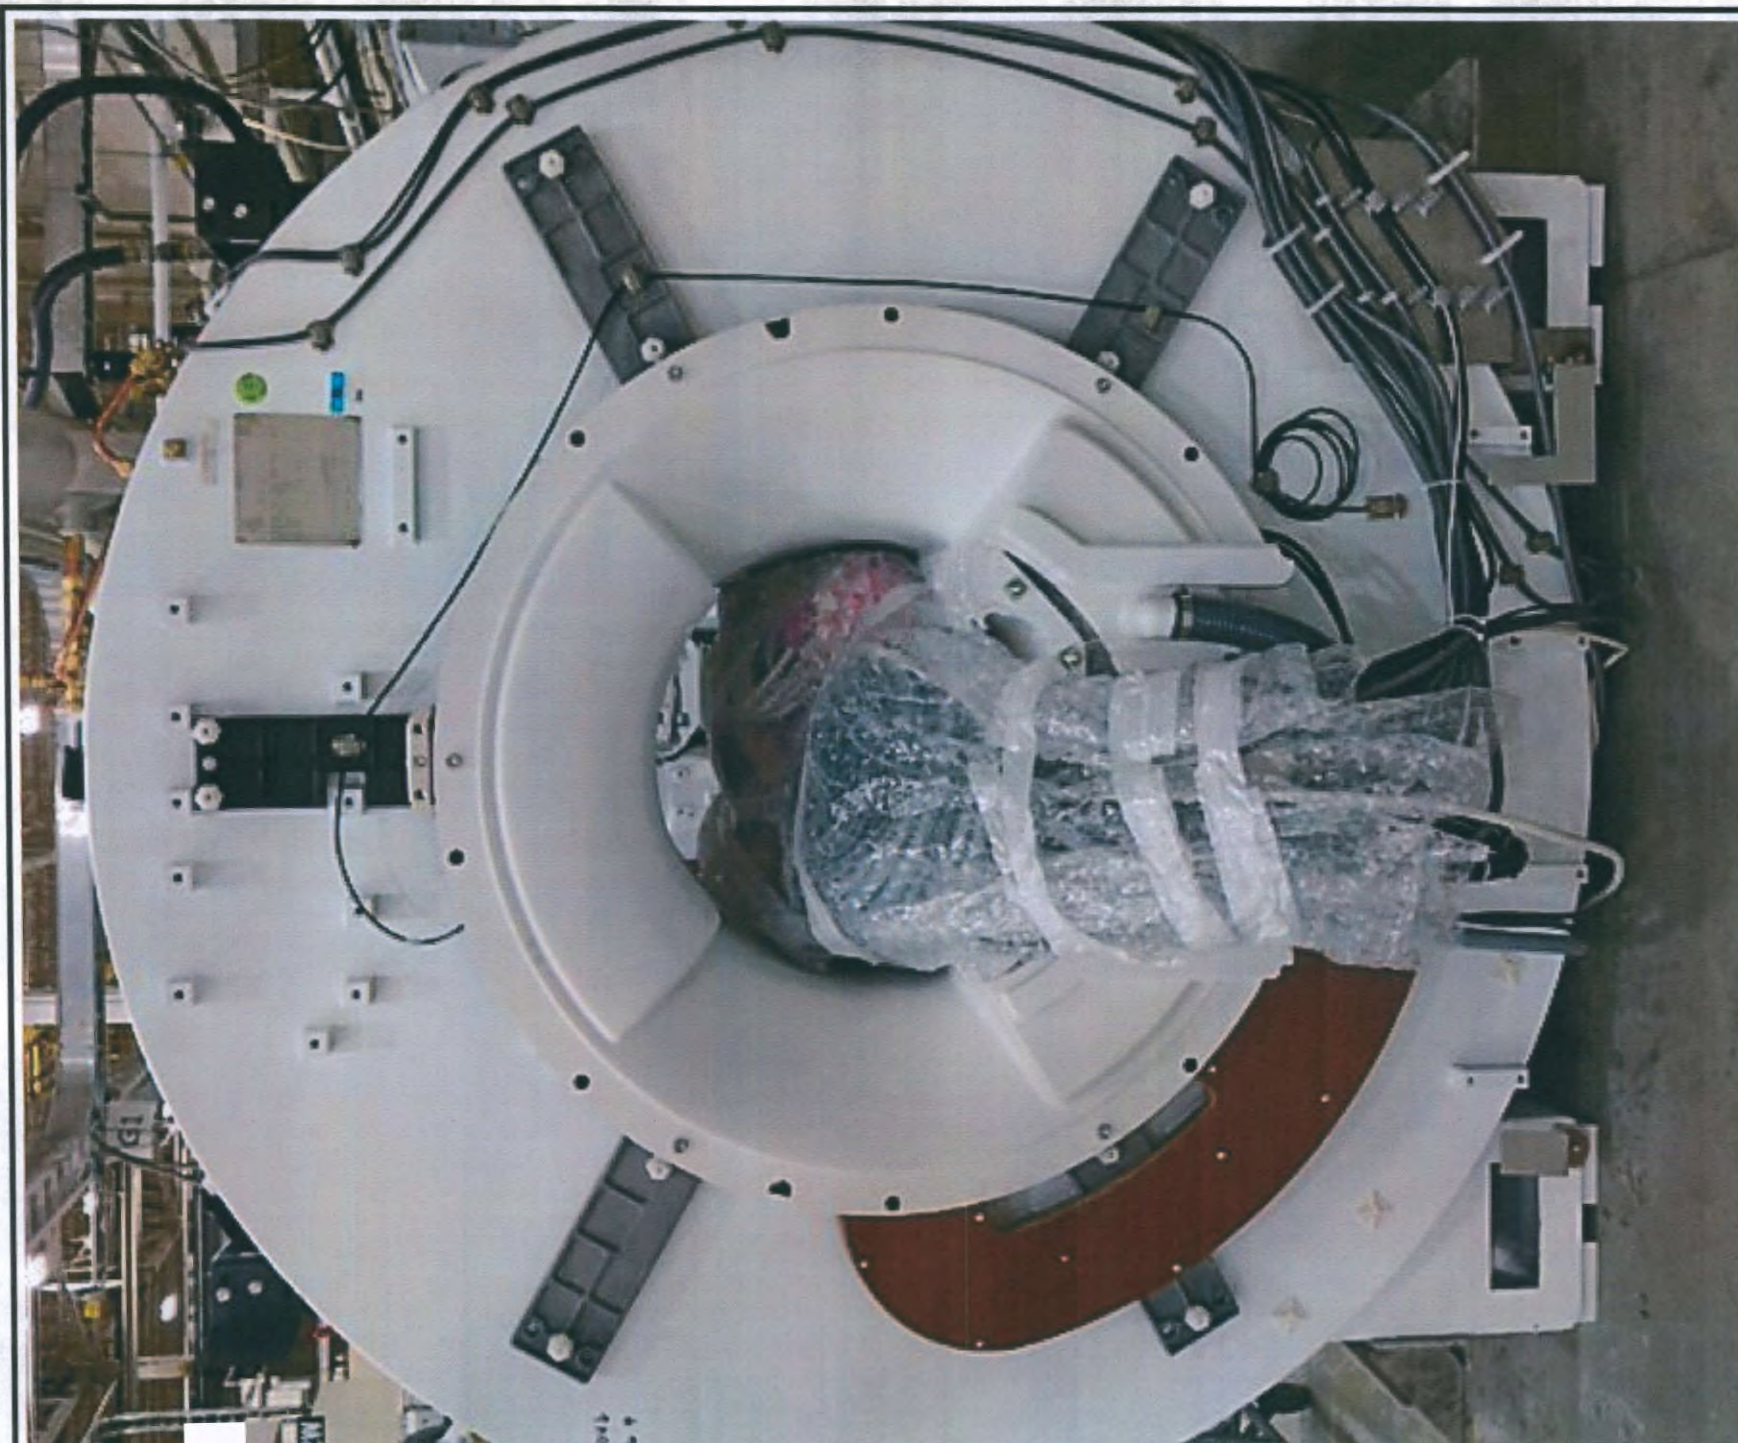

1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

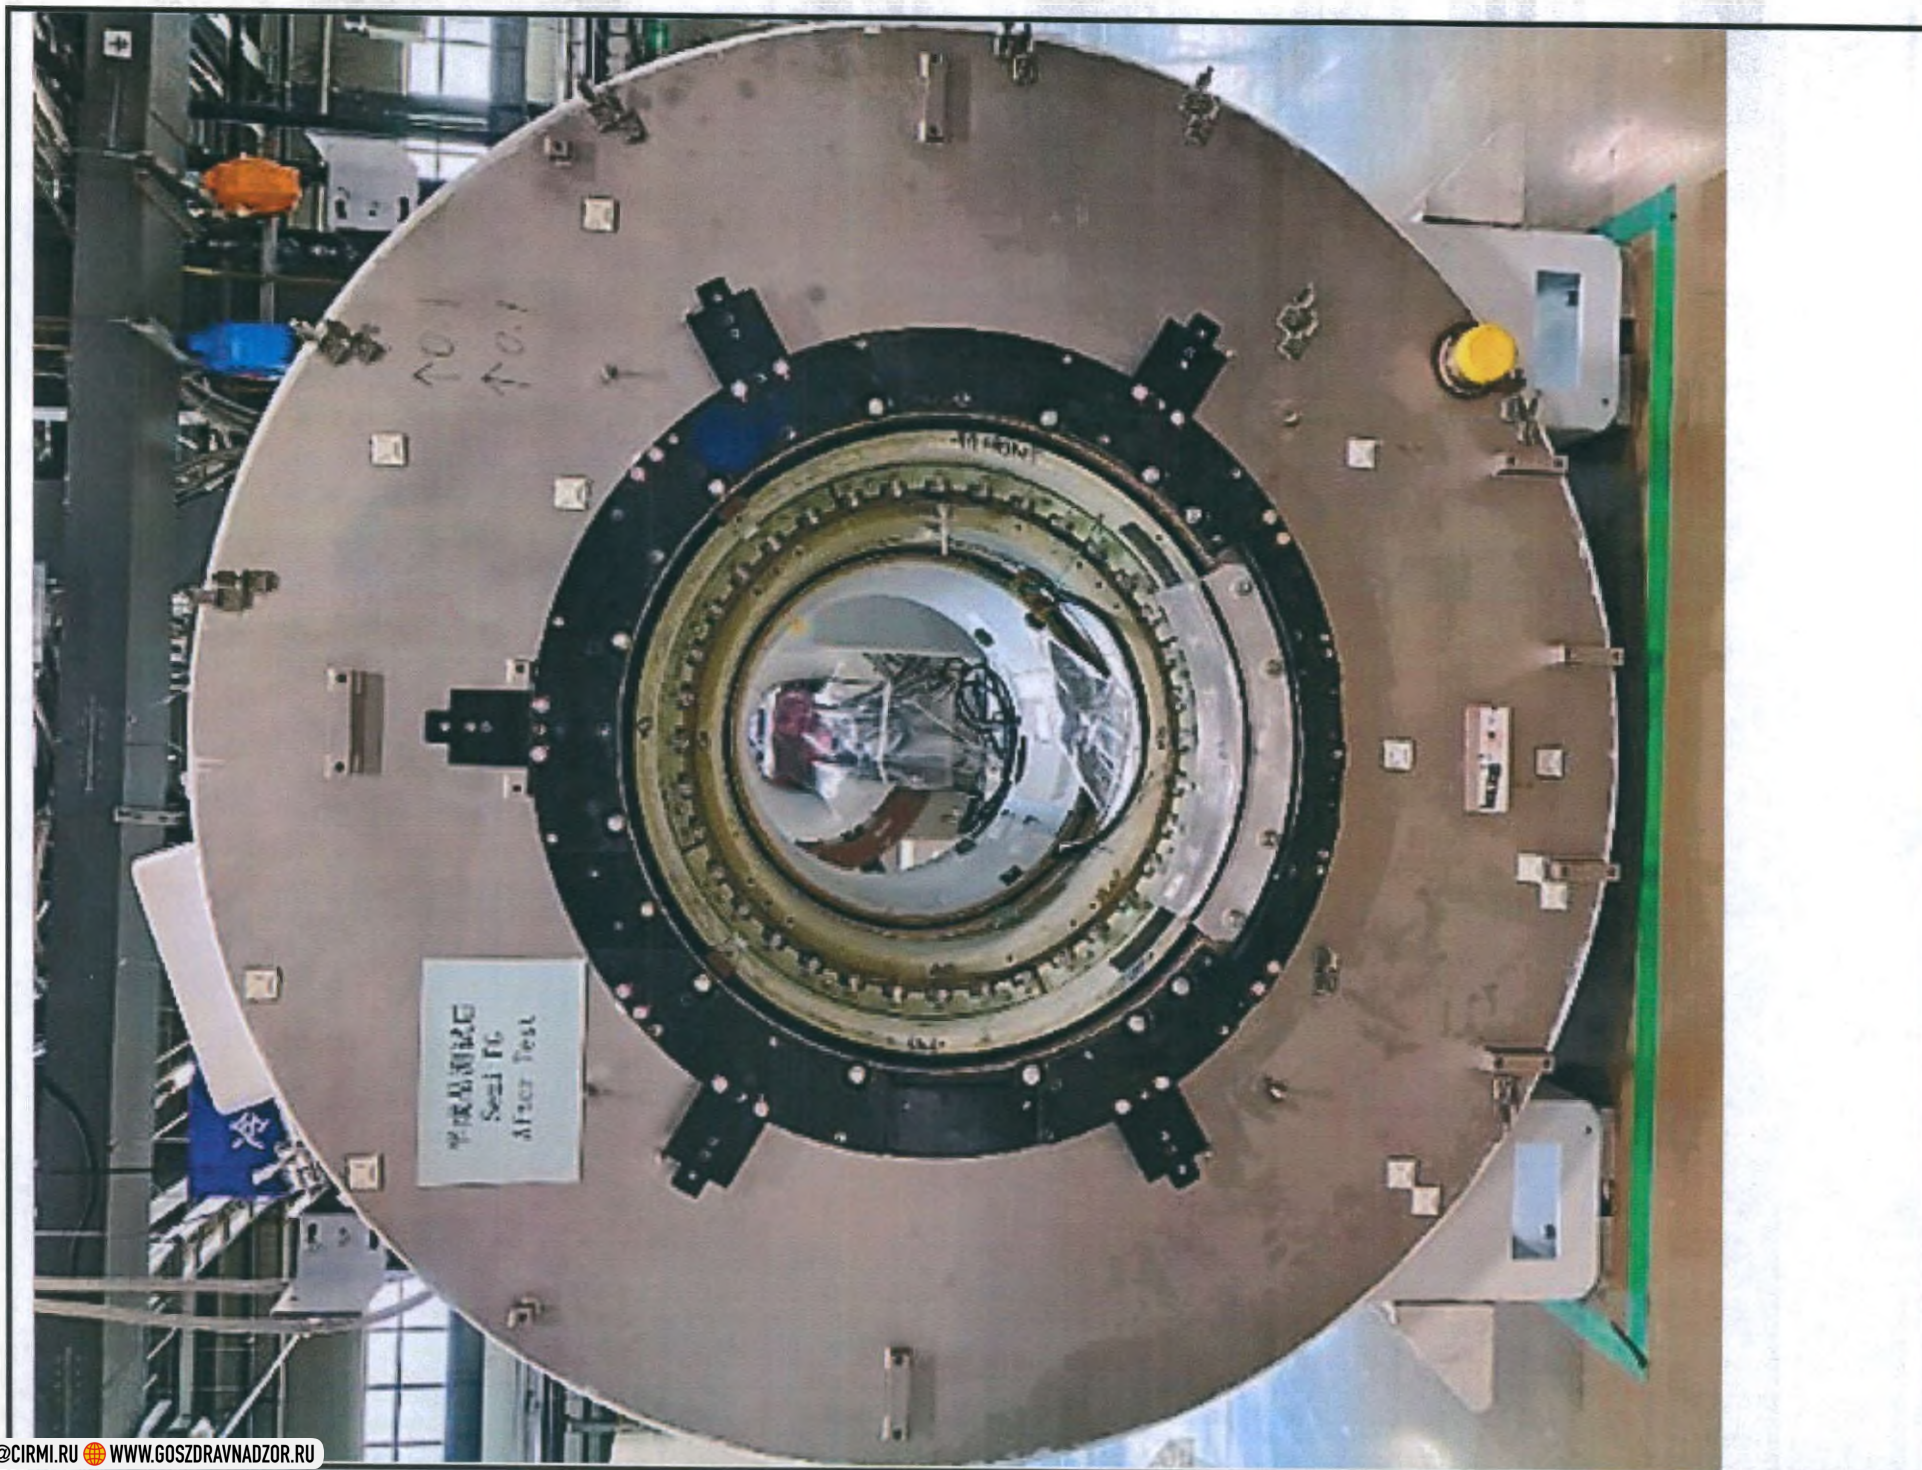


1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.




2. Консоль оператора для ручного управления сканированием, расположенным на передней панели магнита.




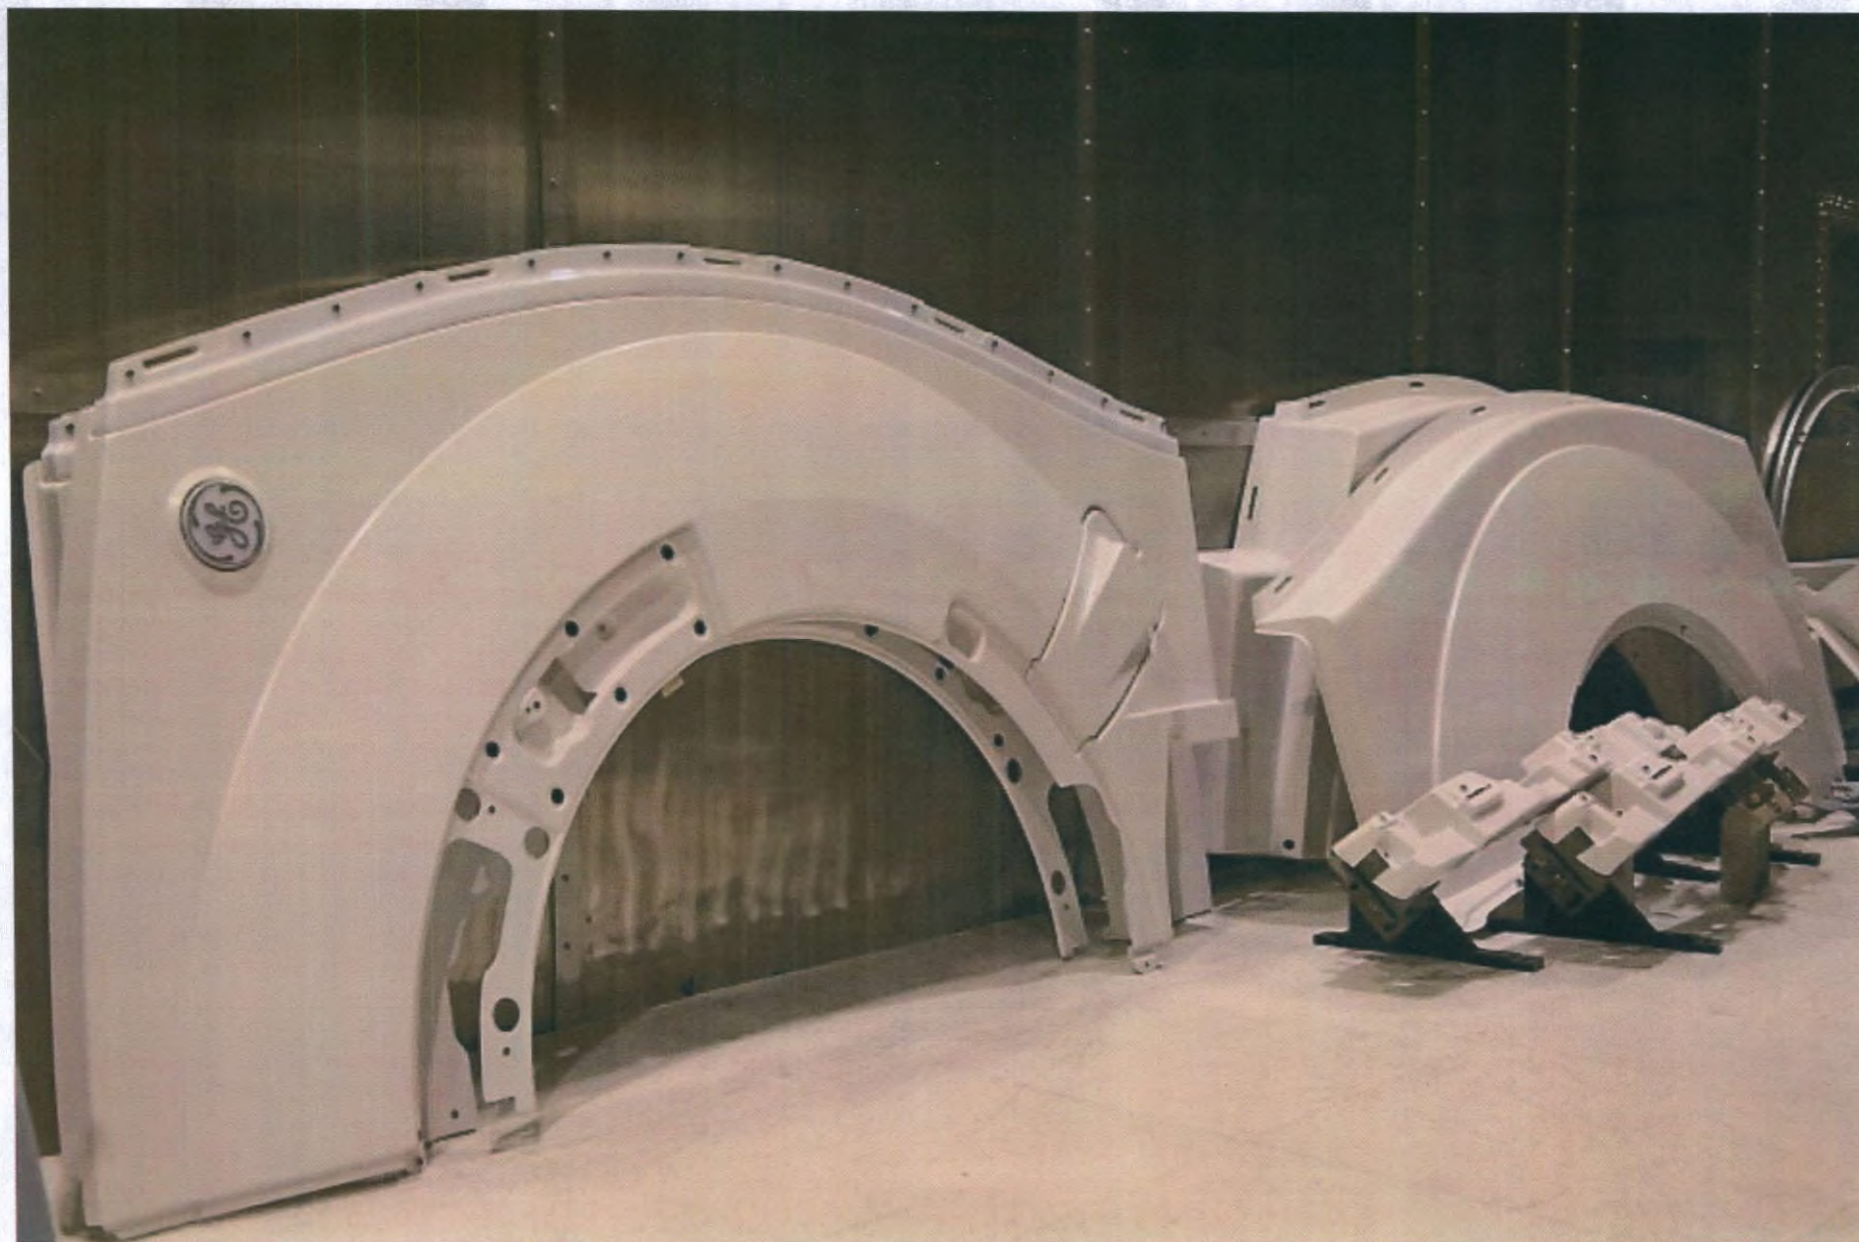




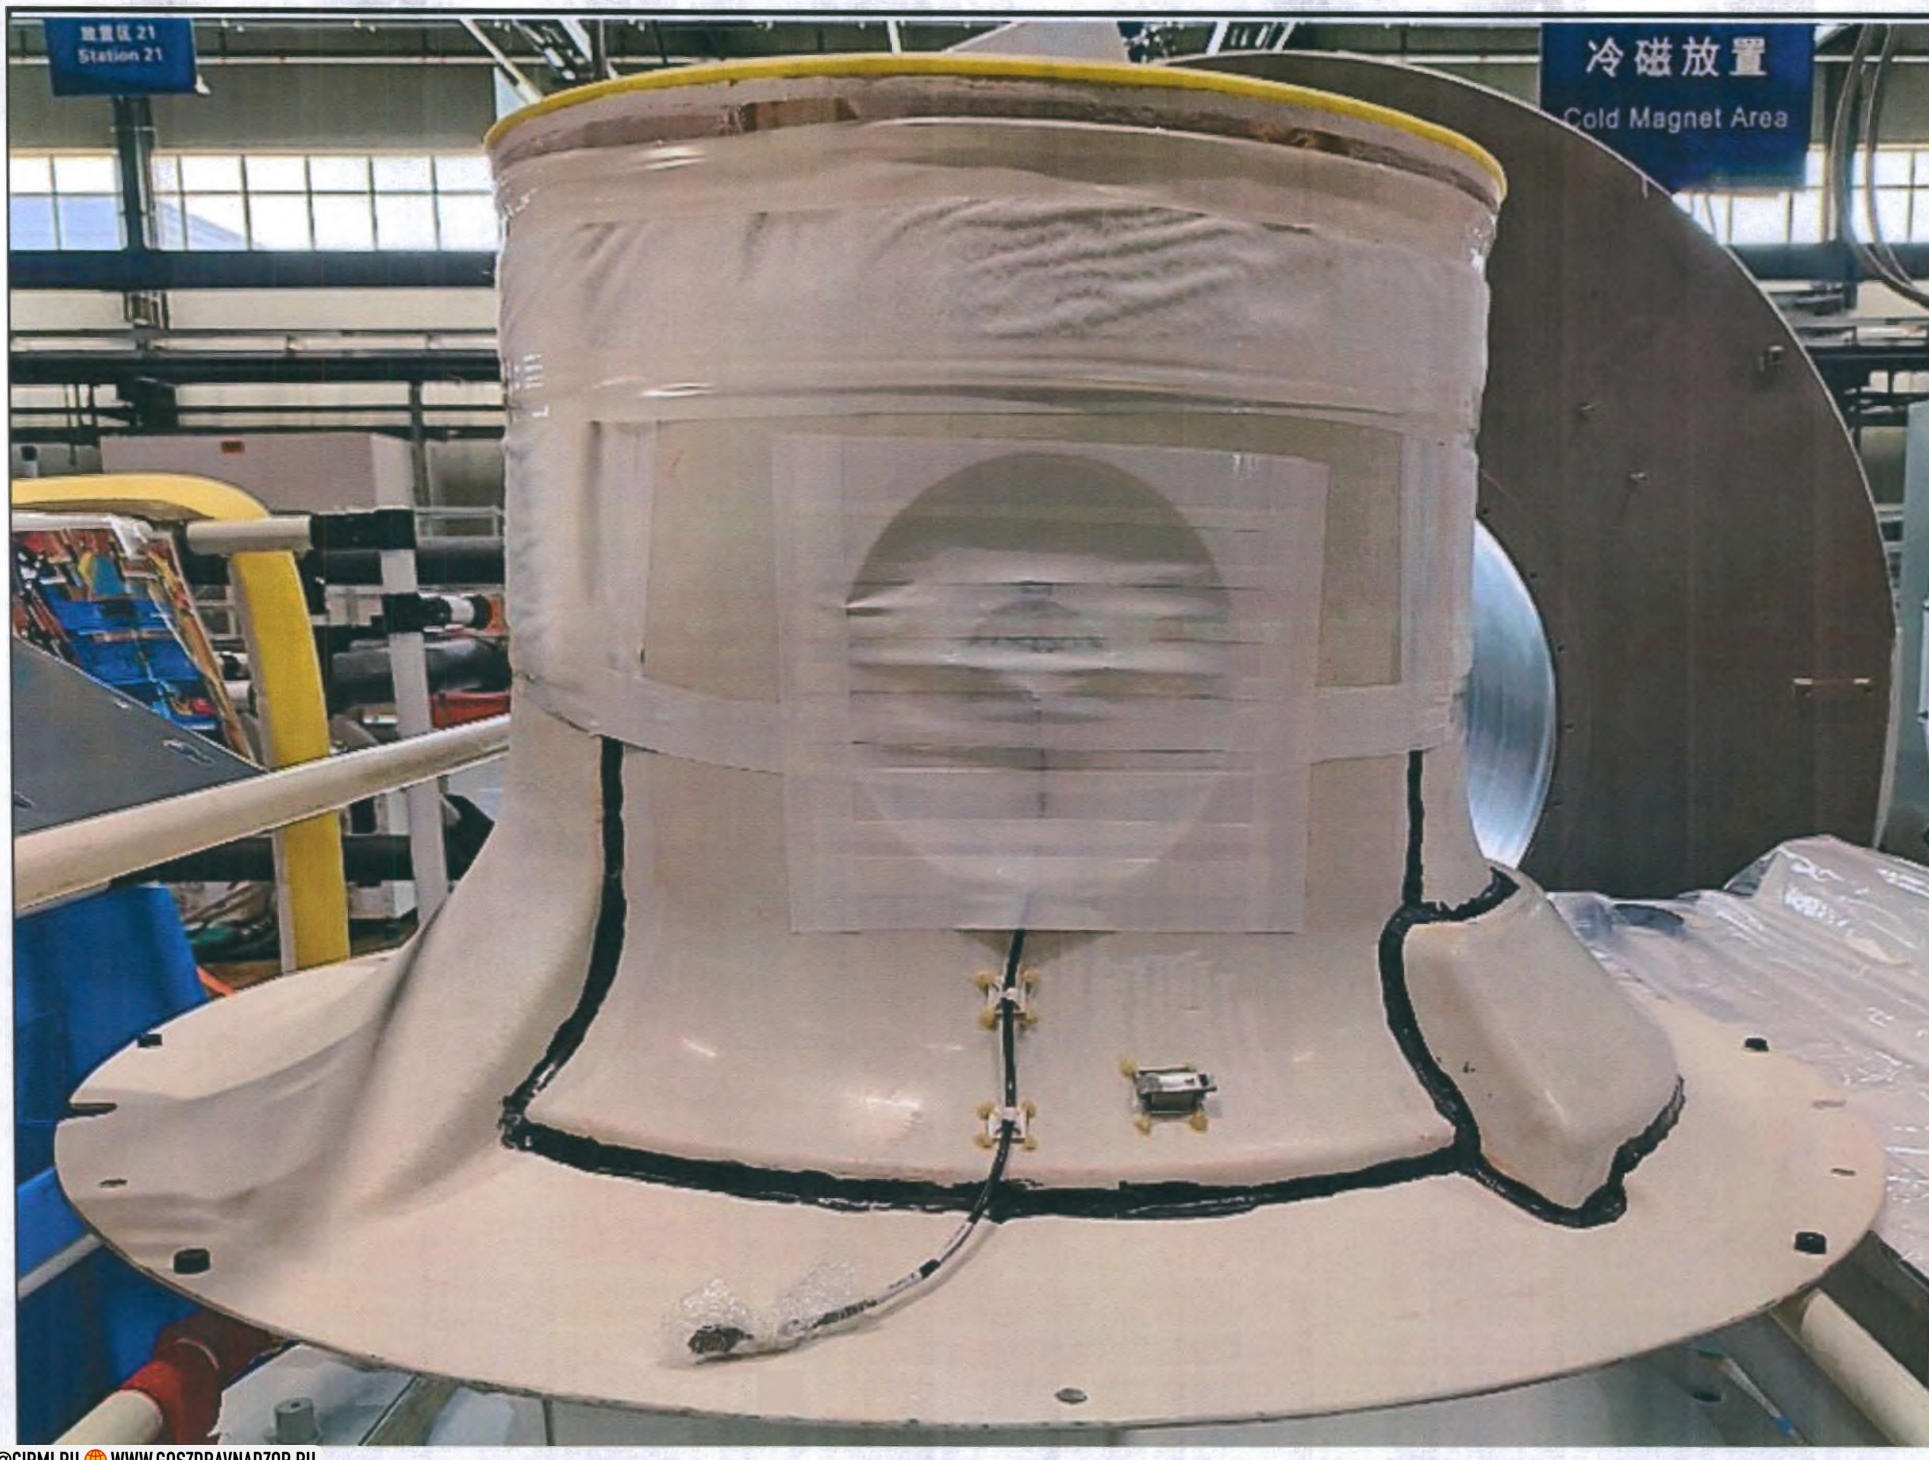


3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).

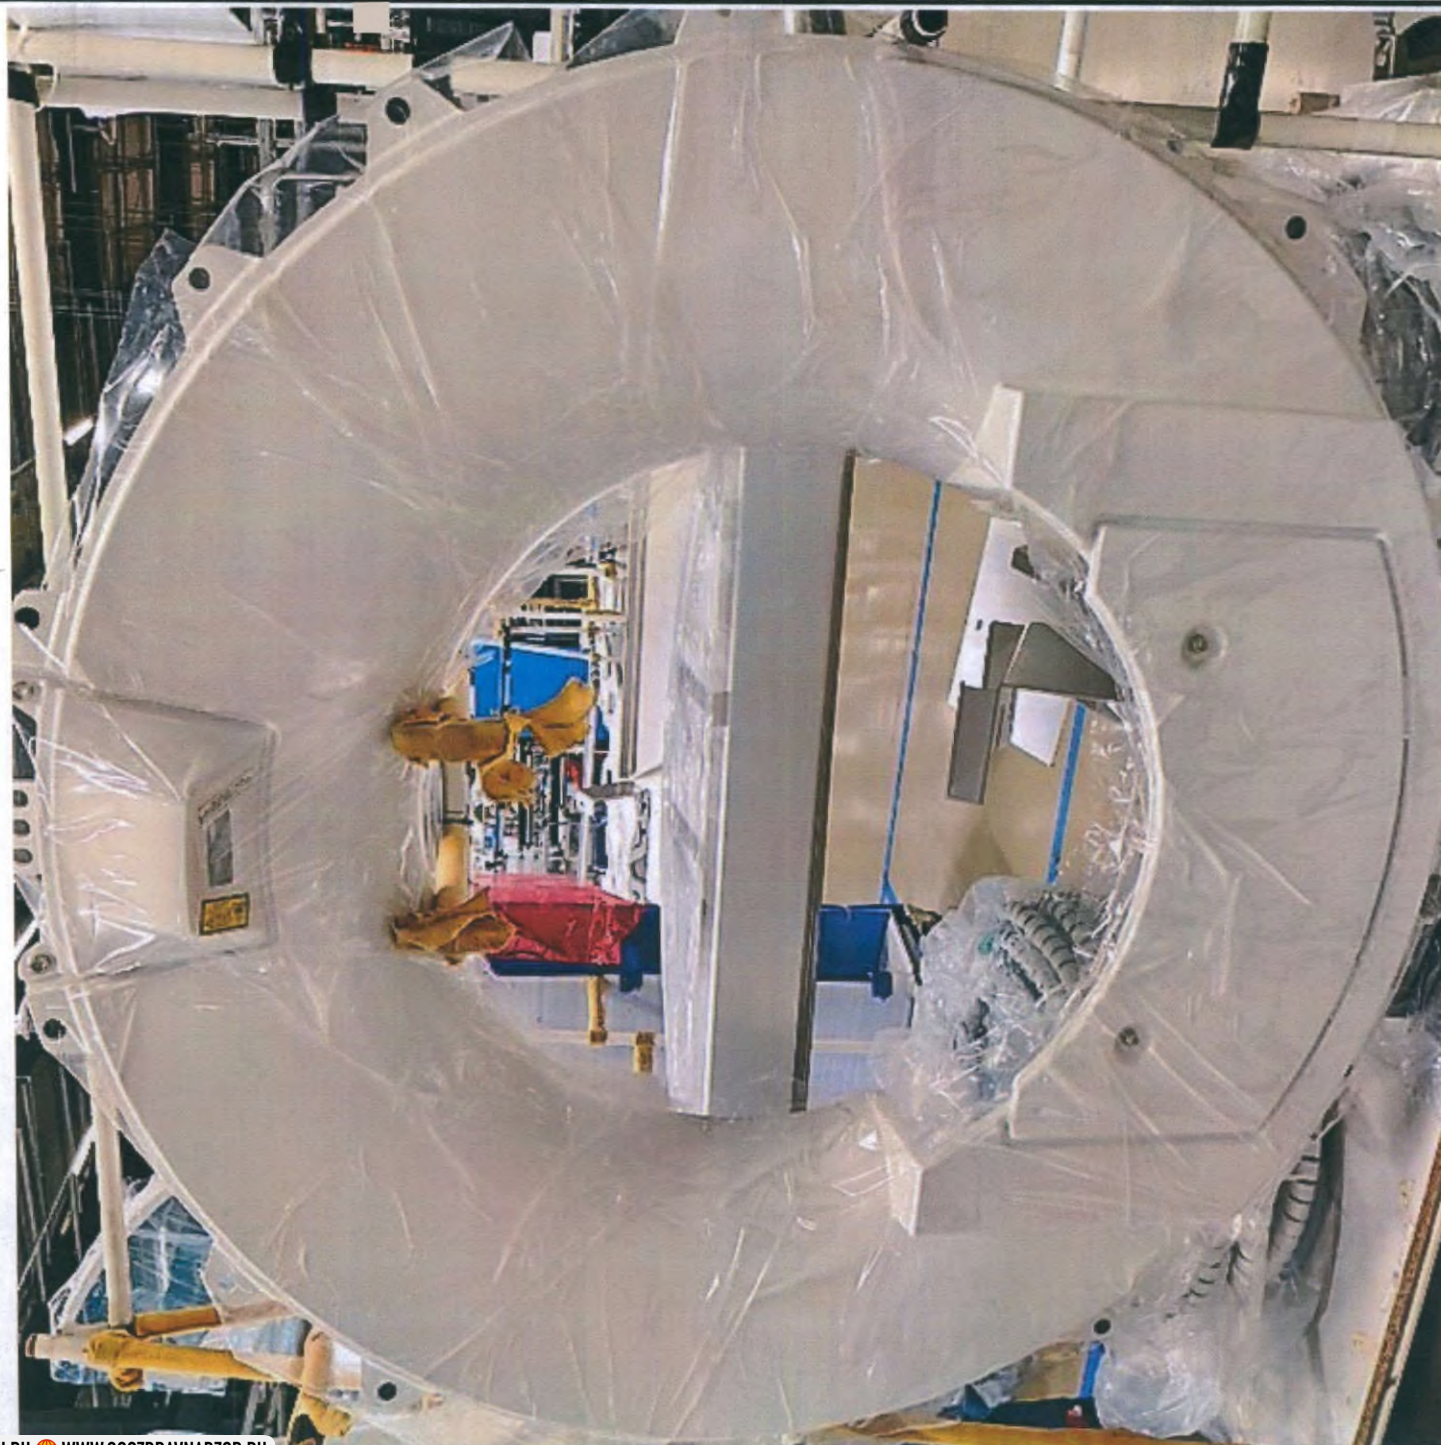



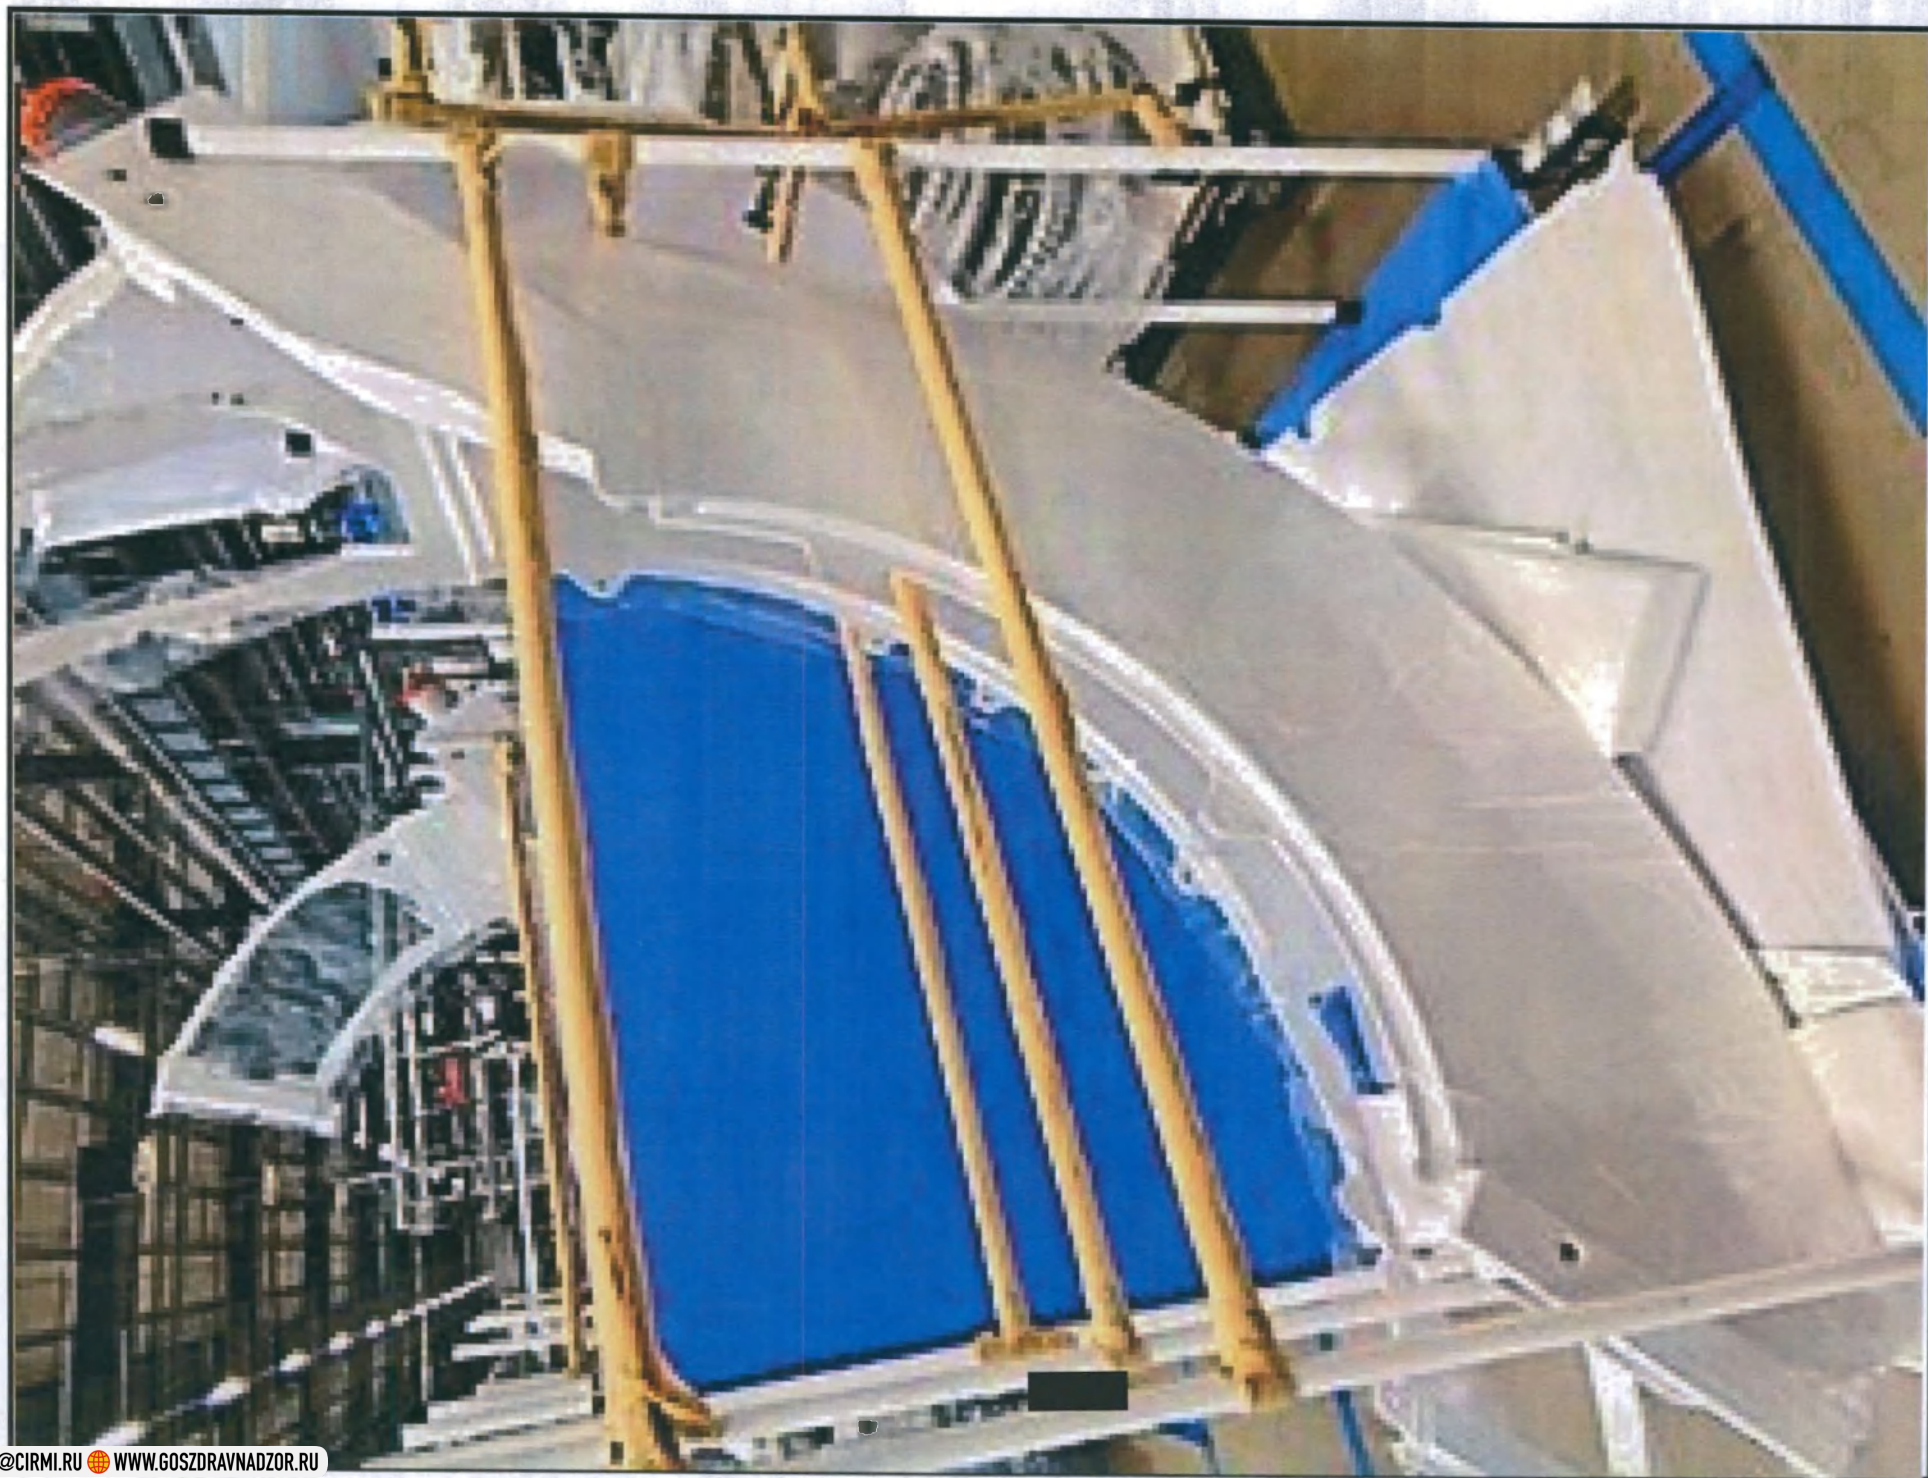

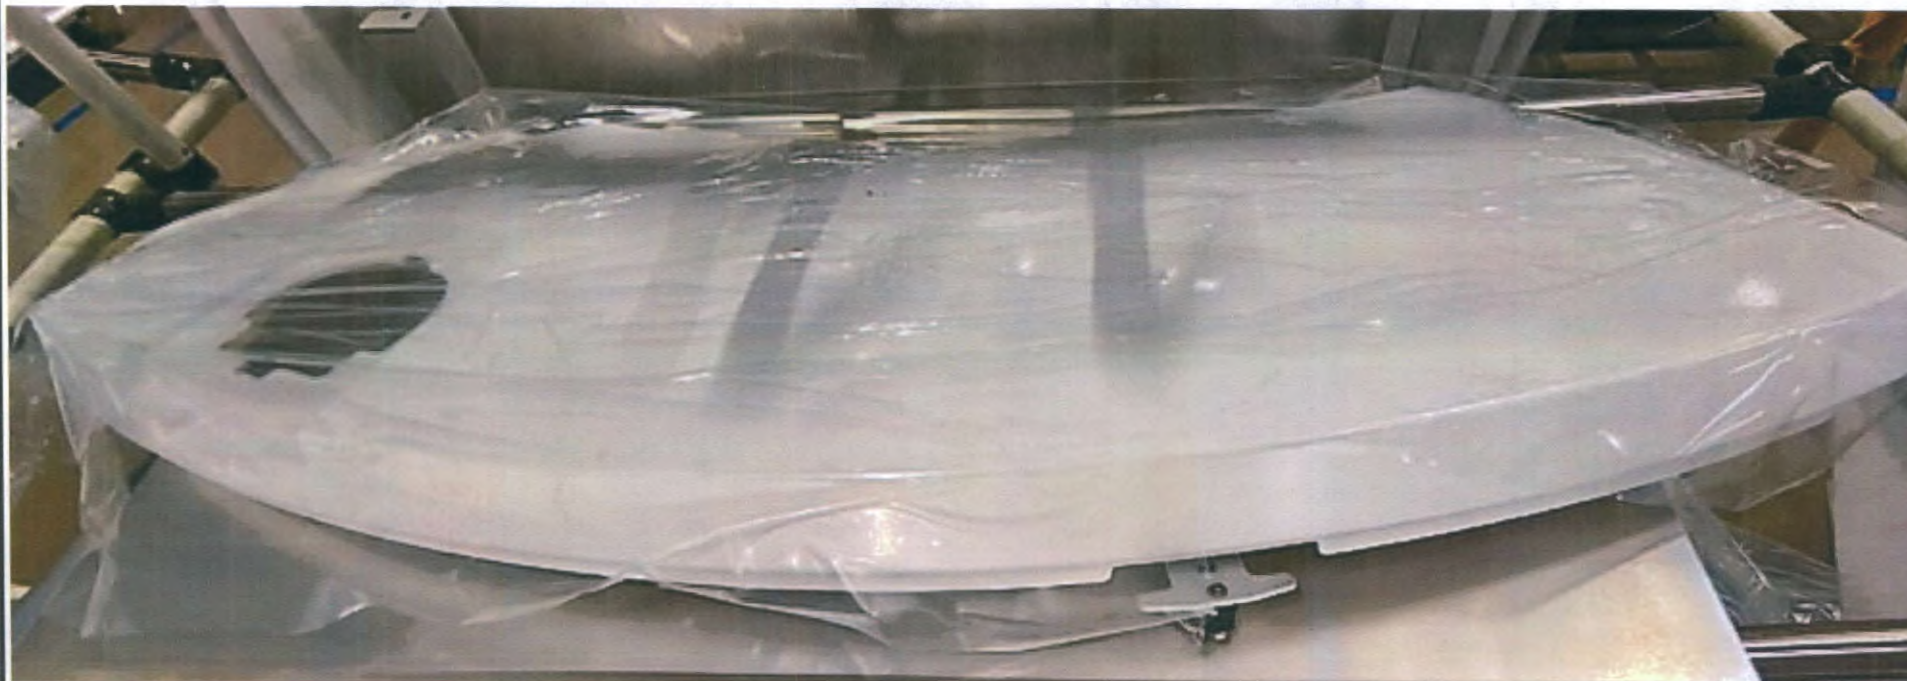











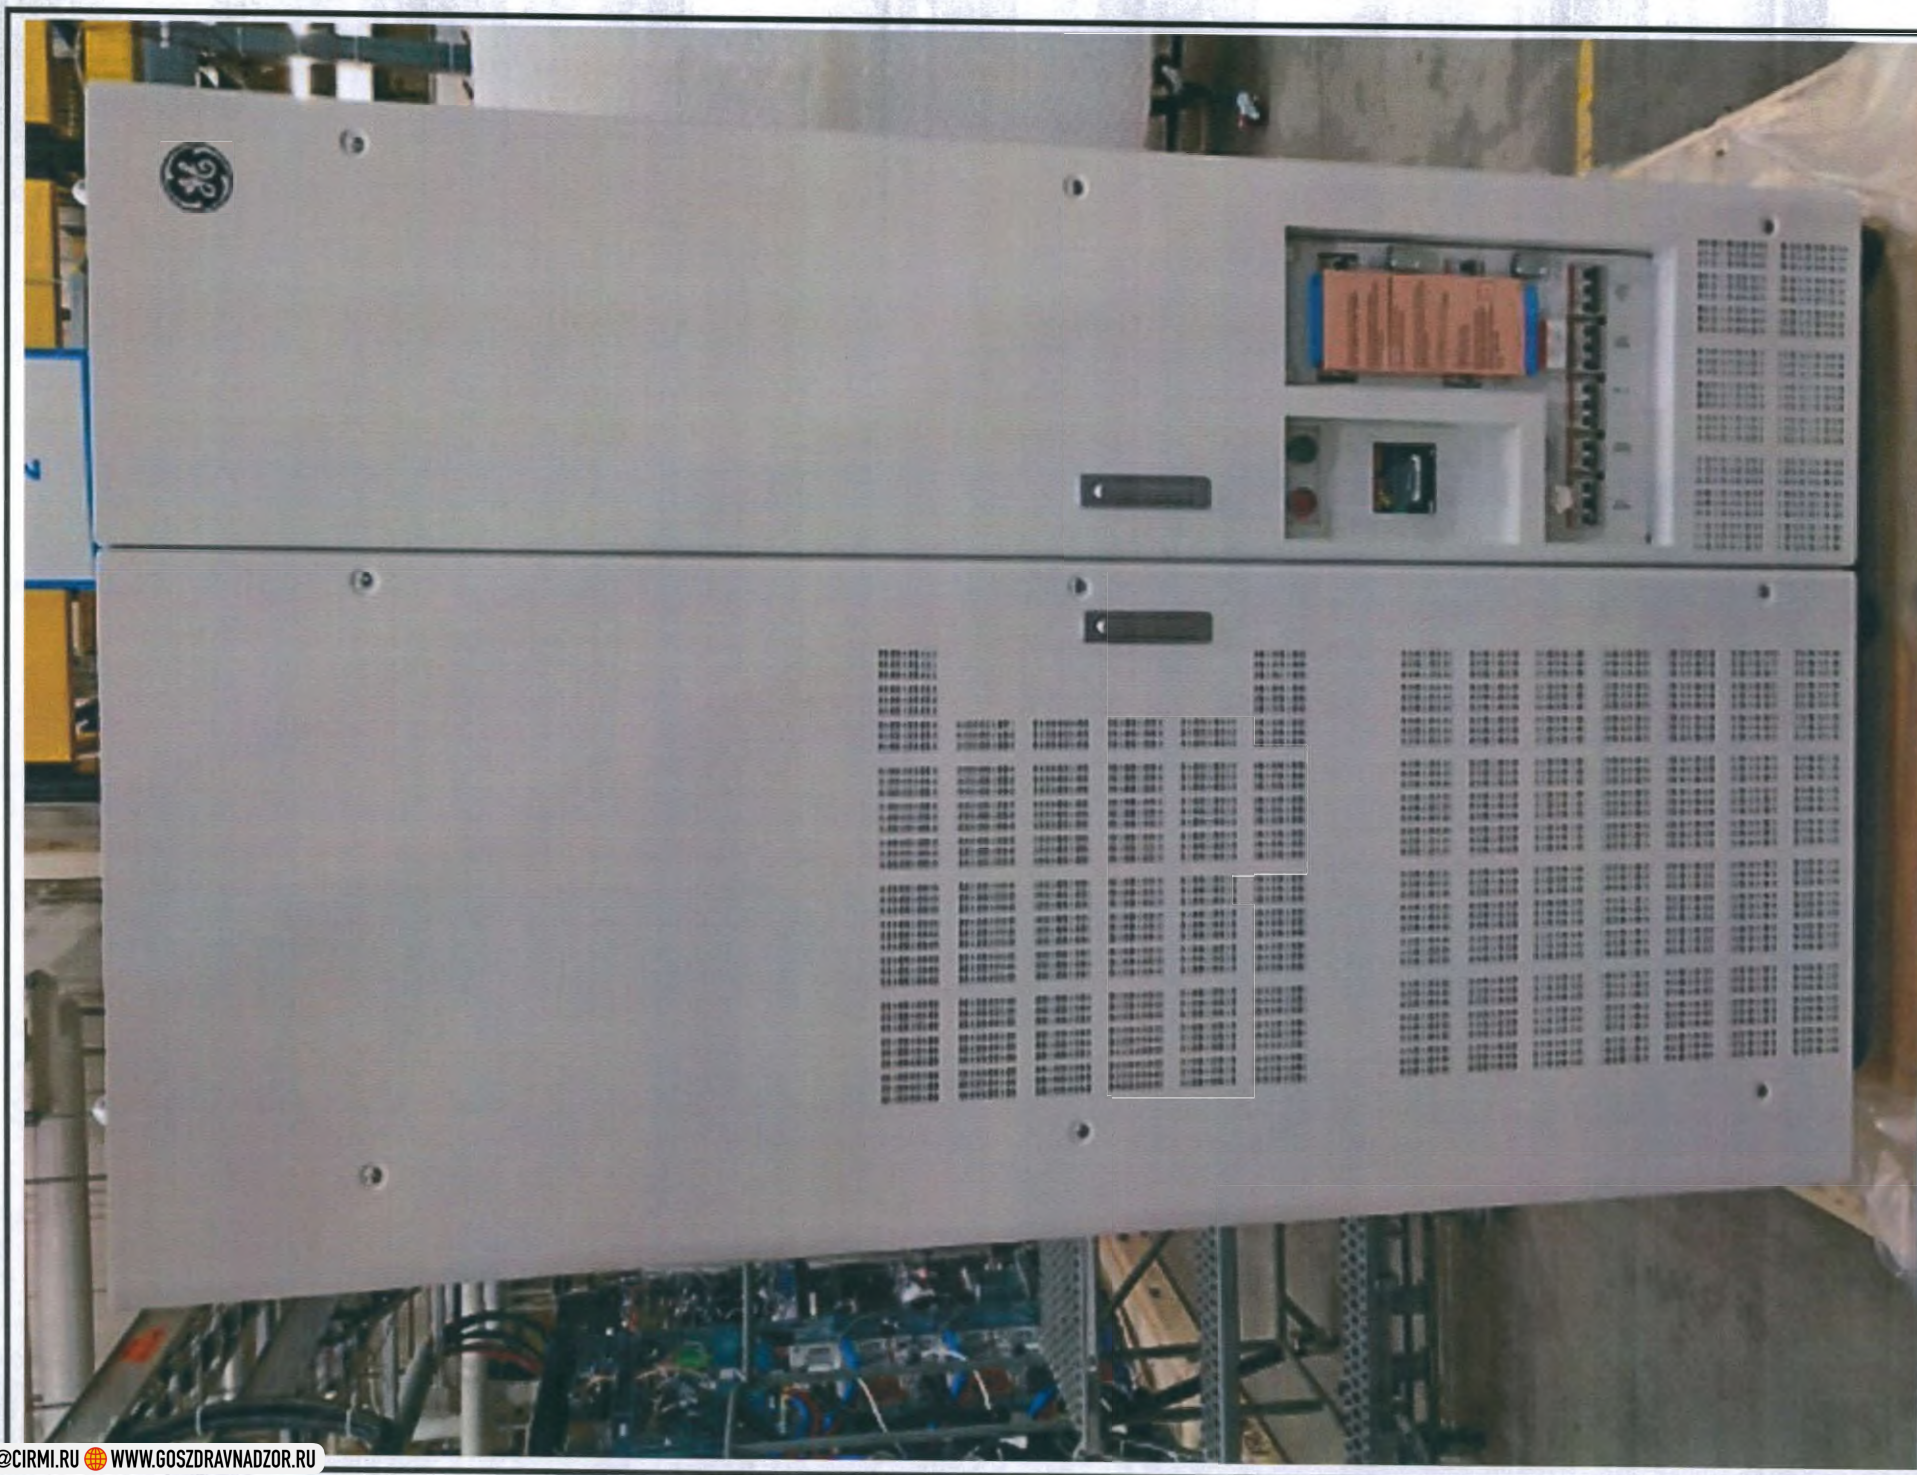



6. Стол пациента, вариант исполнения: Низкий фиксированный.



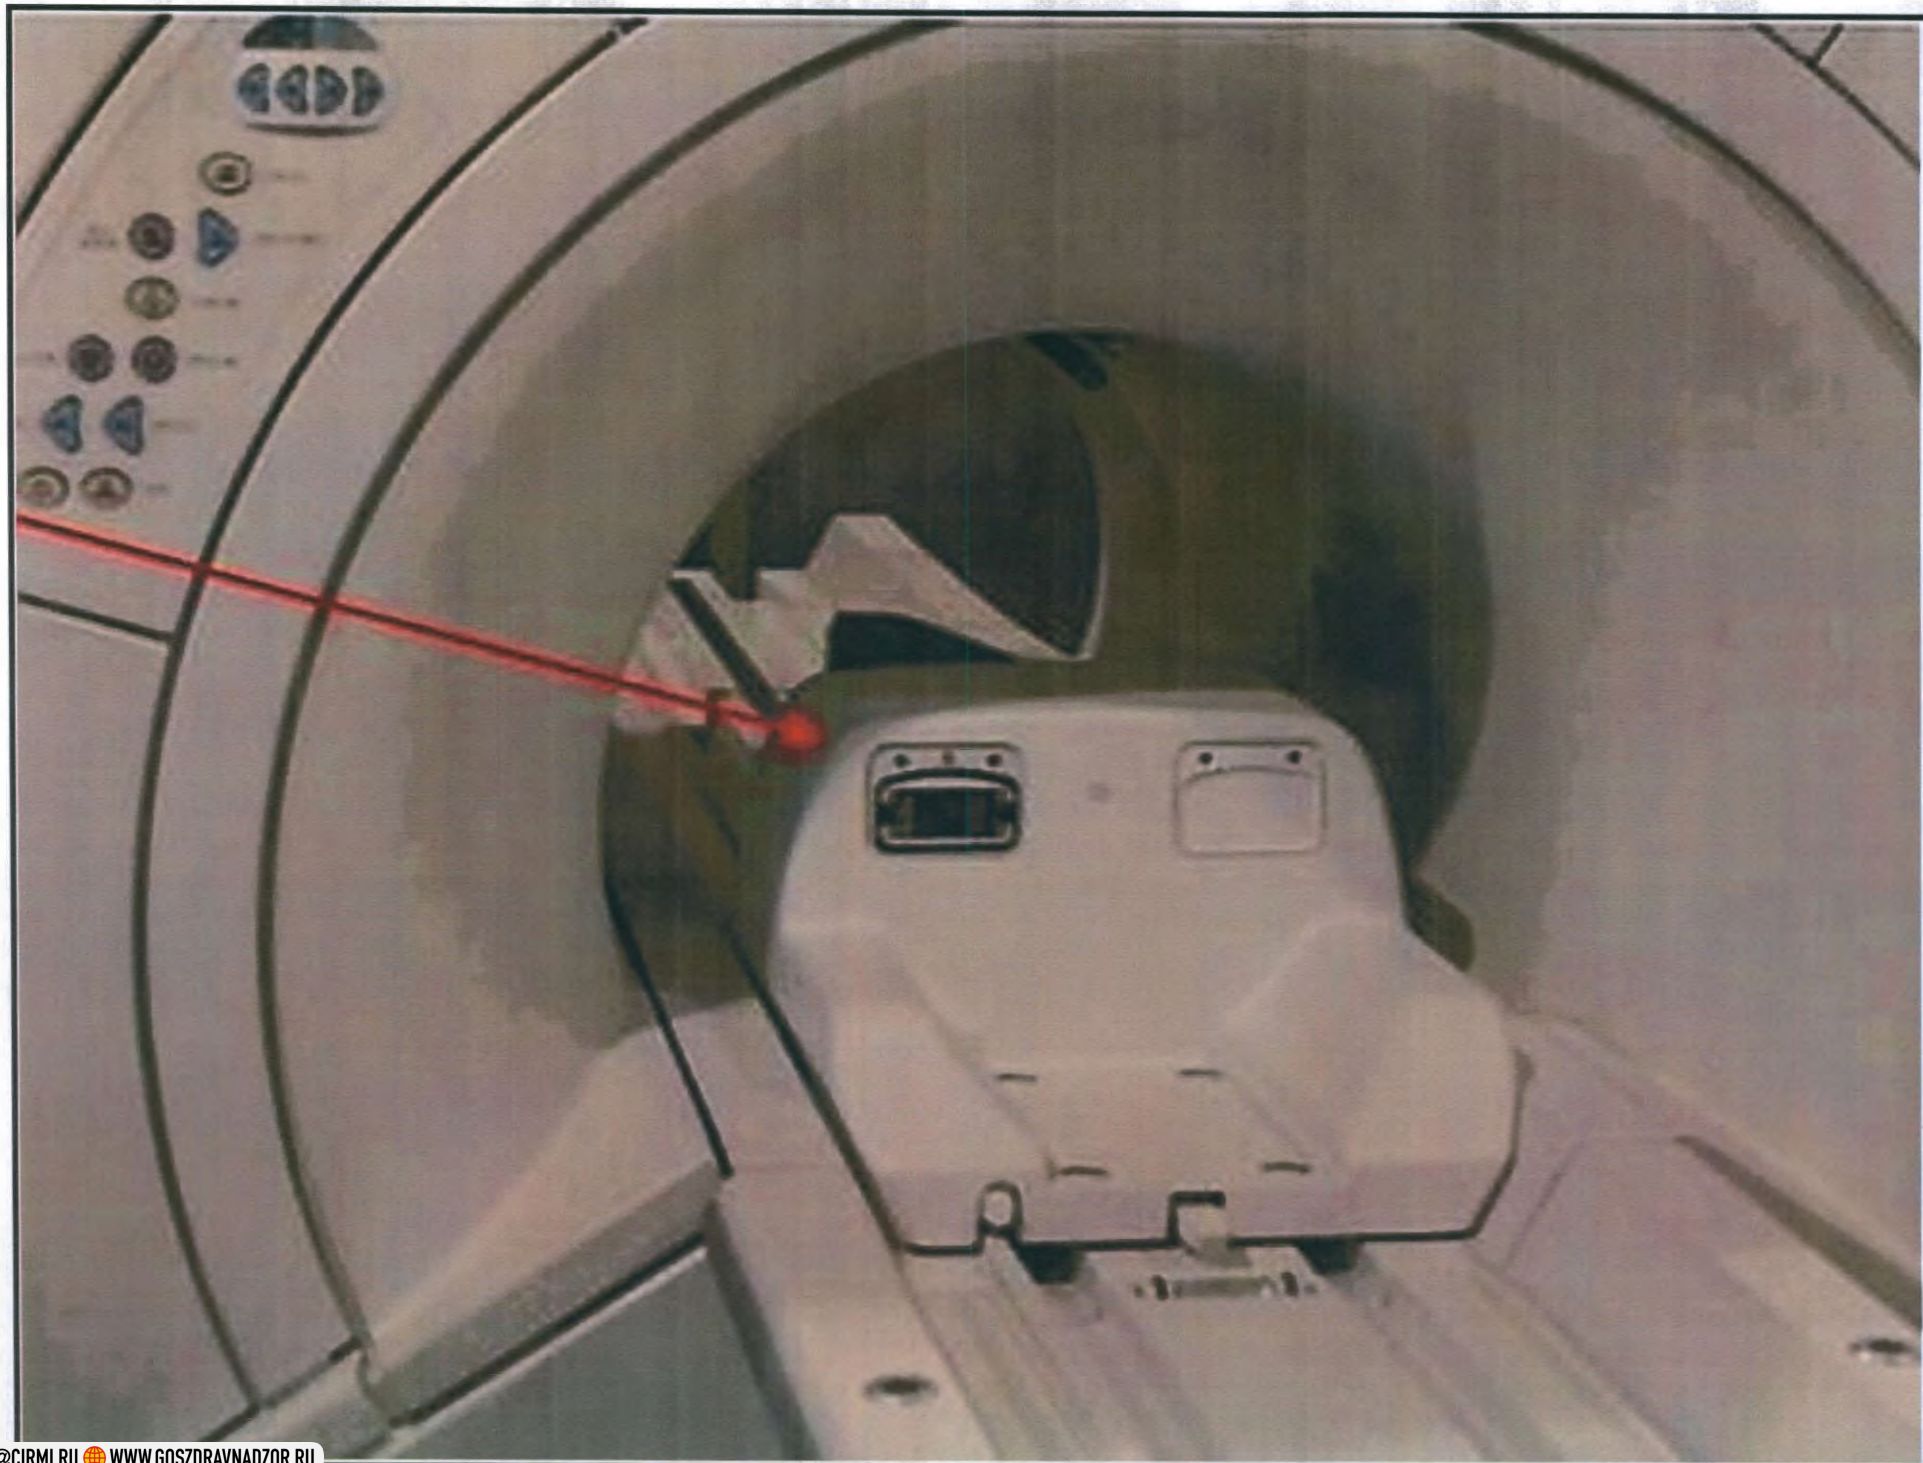

7. Порт консоли катушки.

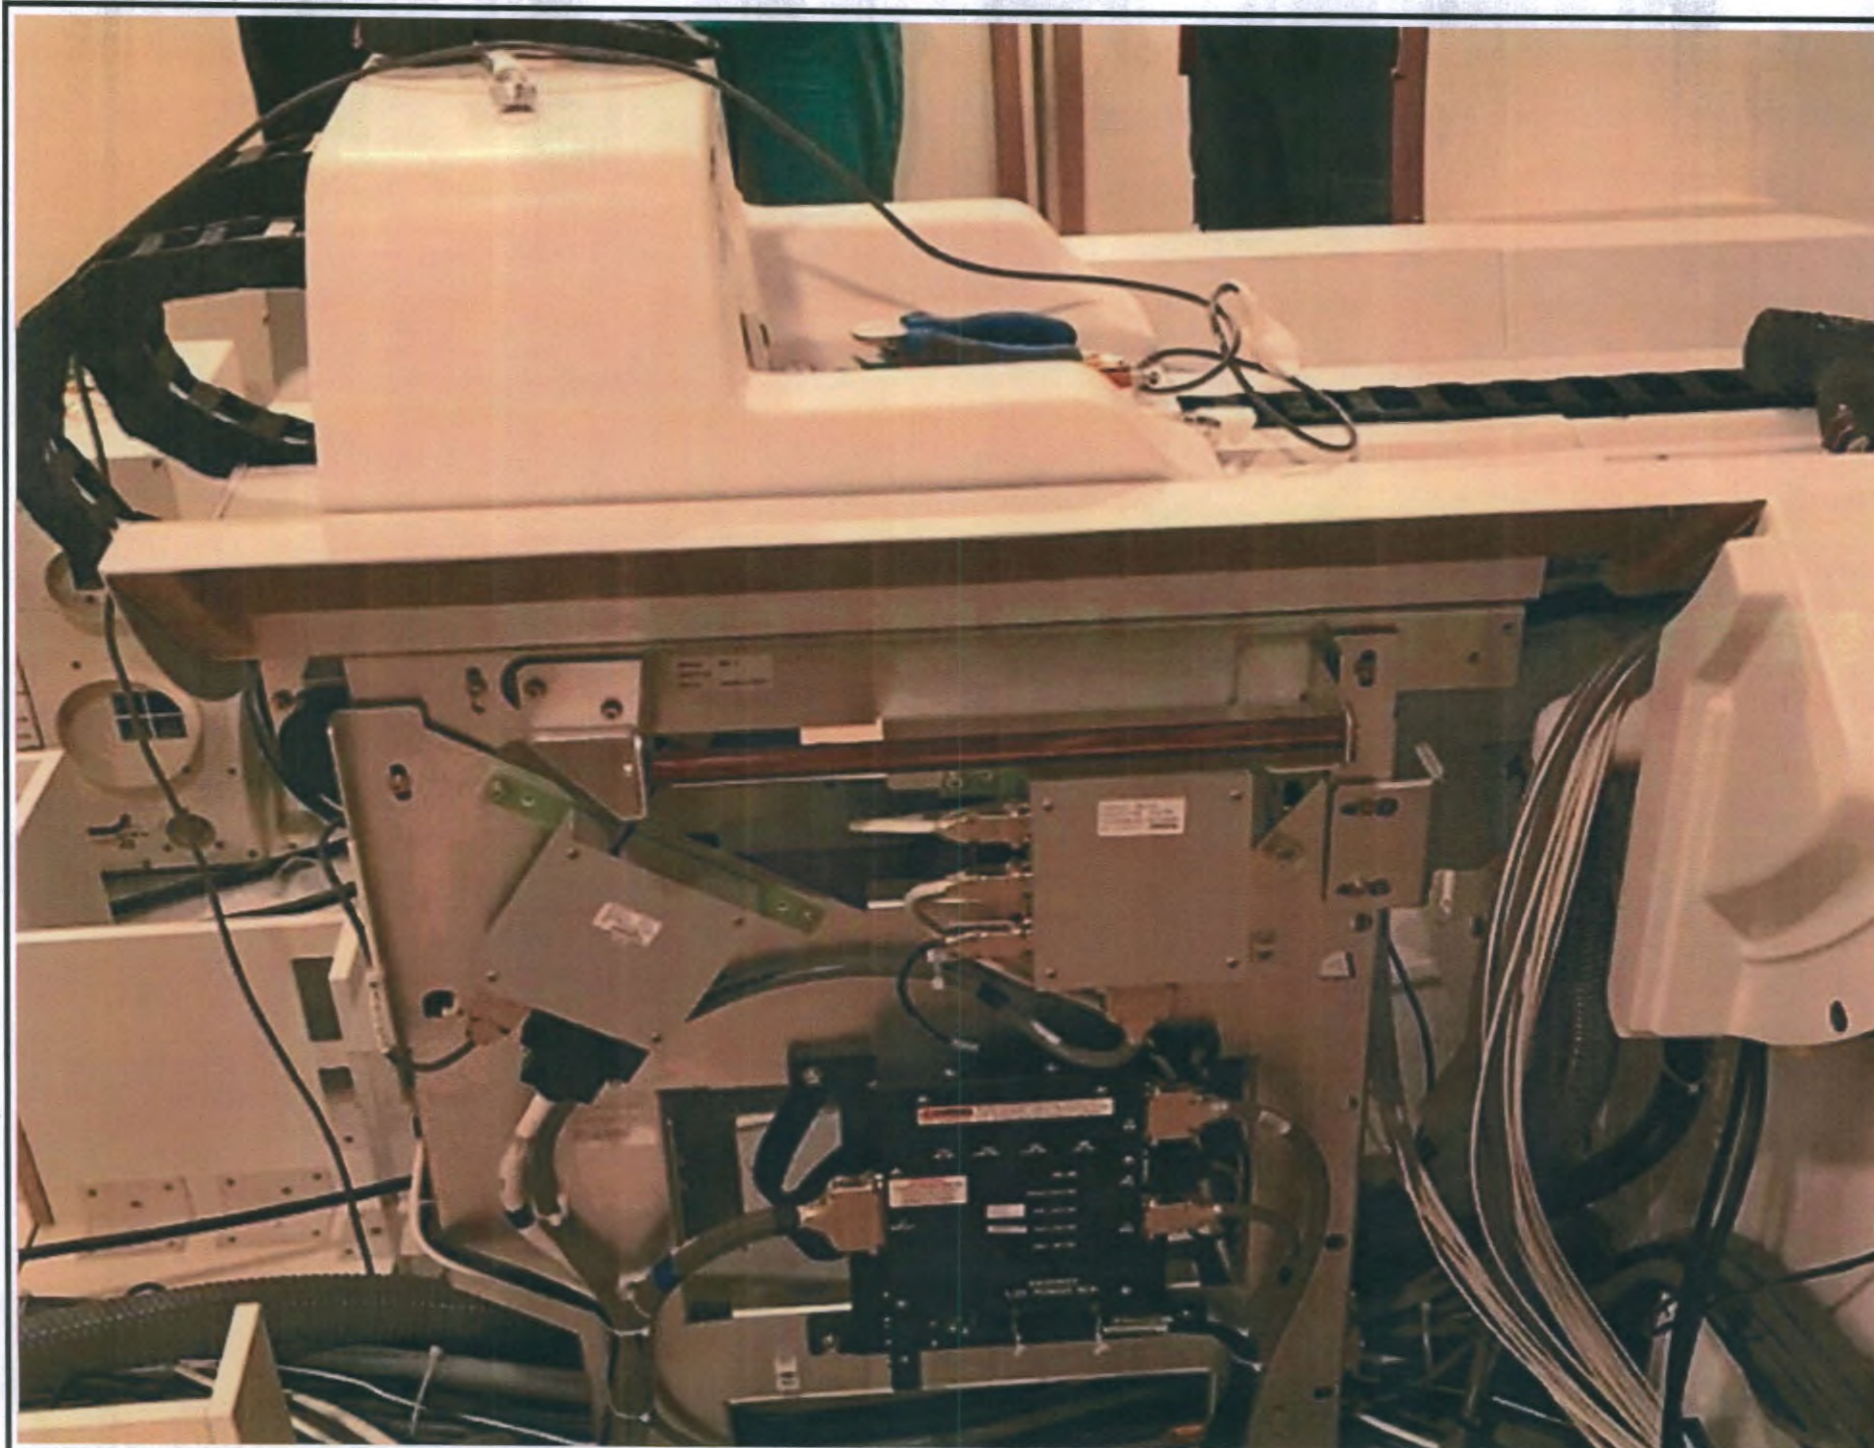

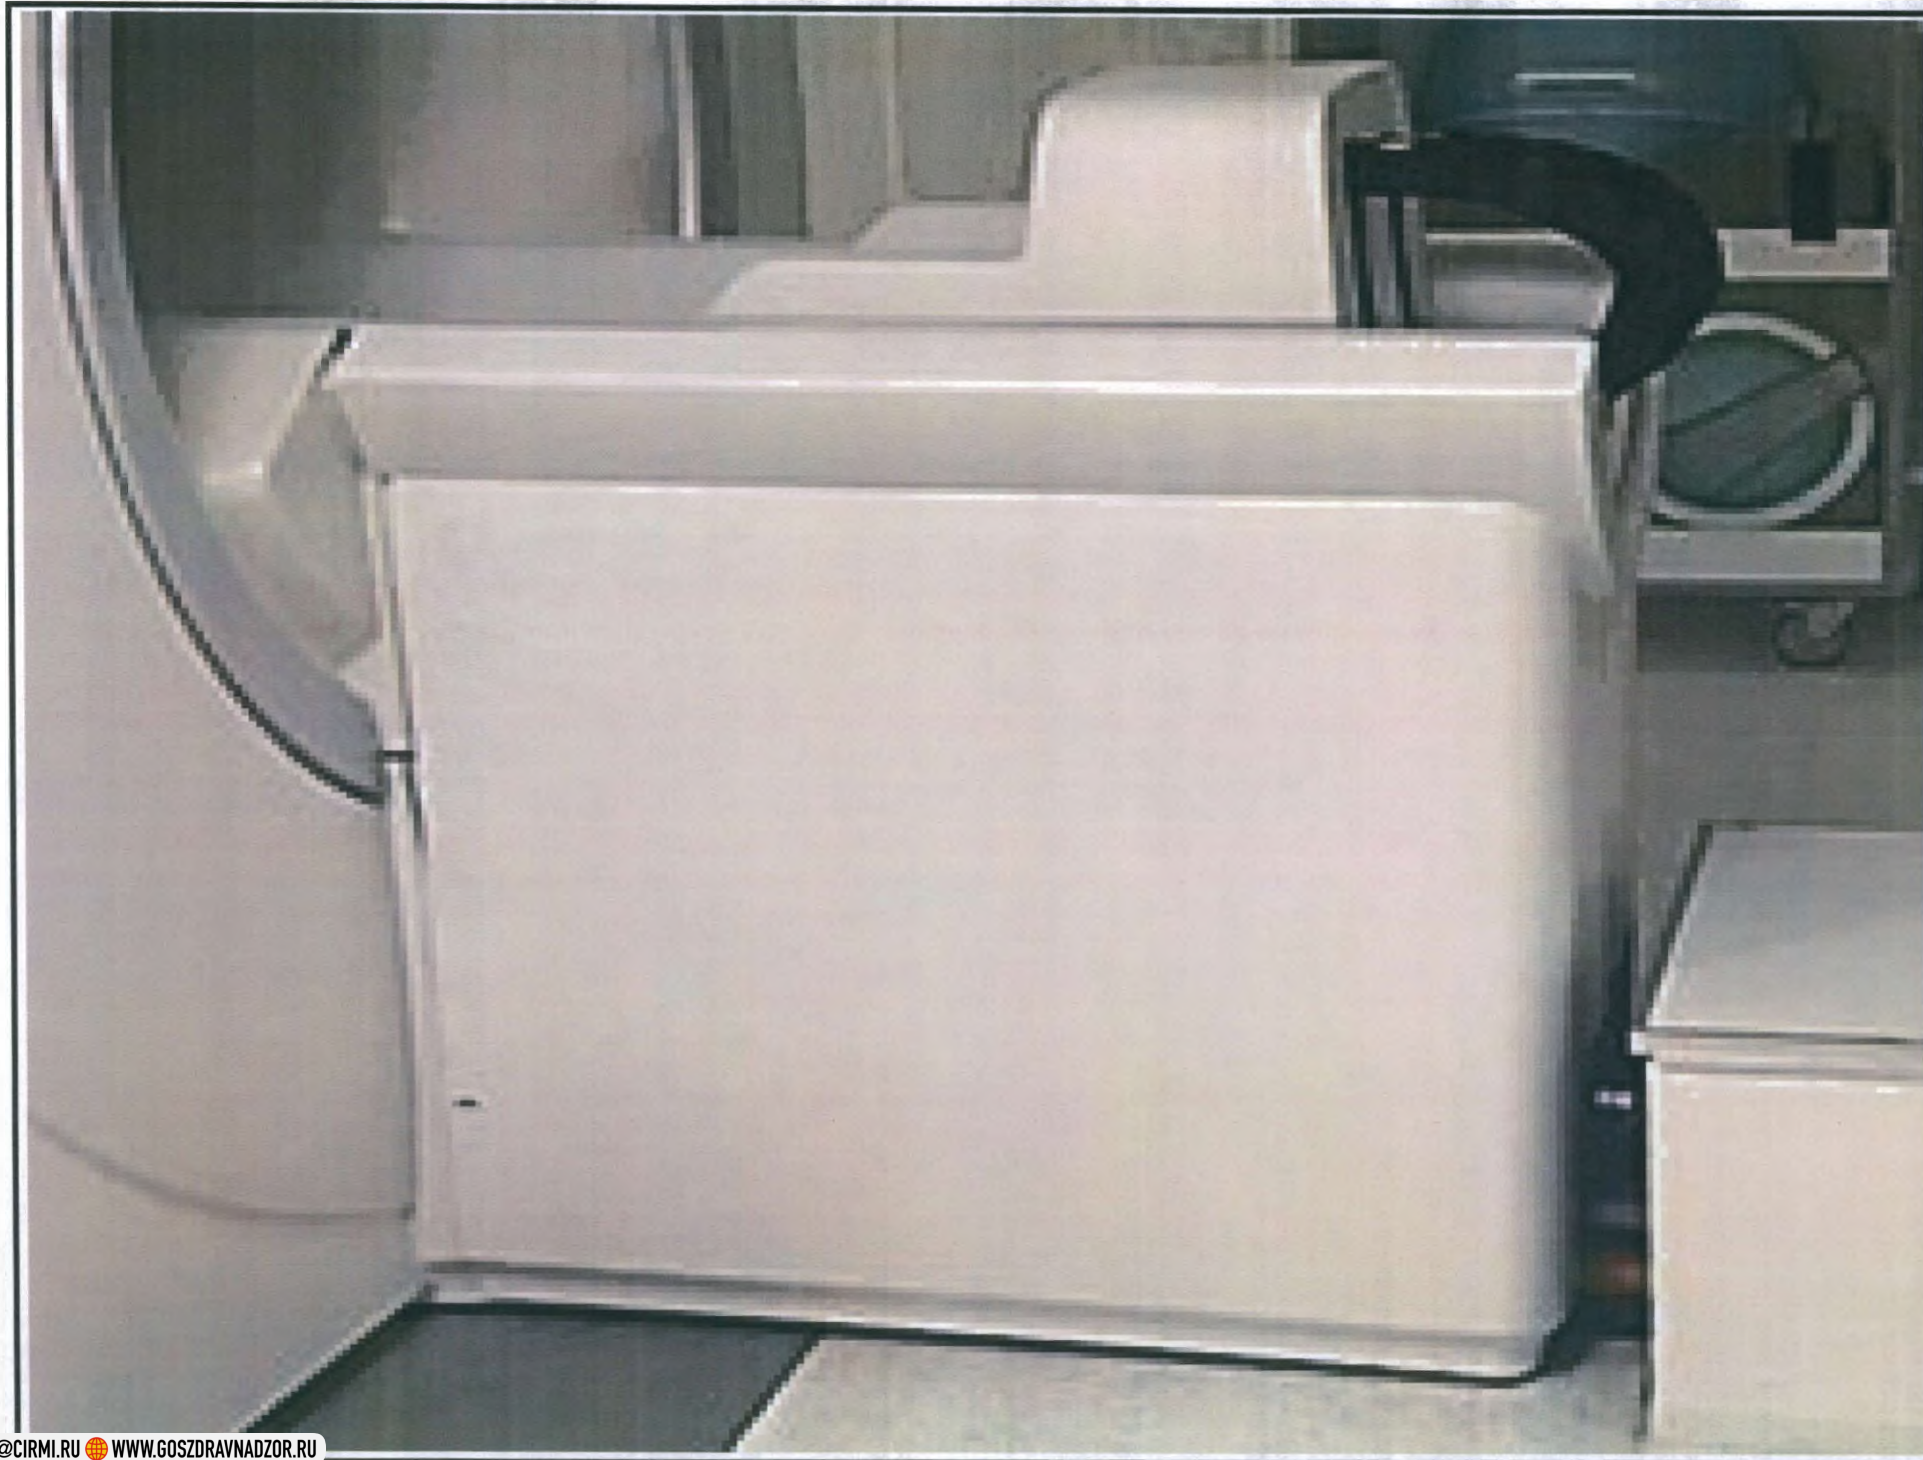

Томограф магнитно-резонансный SIGNA, варианты исполнения:

- SIGNA Creator,
- SIGNA Explorer

Руководство оператора

Этот документ является руководством оператора, общим для моделей SIGNA Creator и SIGNA Explorer. Имеющиеся функции, катушки и области применения будут различаться в зависимости от выбранной конфигурации системы. Дополнительную информацию по основам работы, а также скриншоты можно получить в учебной программе на английском языке.



Системы 1.5T MR

Руководство оператора, русский язык

6339011-299 на русском (07/2021) ред. 1

© 2021 General Electric Company

Все права защищены.

SIGNA Creator SIGNA Explorer Магнитно-резонансная система 1.5T

Руководство оператора



Этот документ является руководством оператора, общим для моделей SIGNA Creator и SIGNA Explorer. Имеющиеся функции, катушки и области применения будут различаться в зависимости от выбранной конфигурации системы. Дополнительную информацию по основам работы, а также скриншоты можно получить в учебной программе на английском языке.



Системы 1.5T MR

Руководство оператора, русский язык

6339001-299 на русском (2021-06) ред. 2

© 2021 General Electric Company

Все права защищены.






9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).

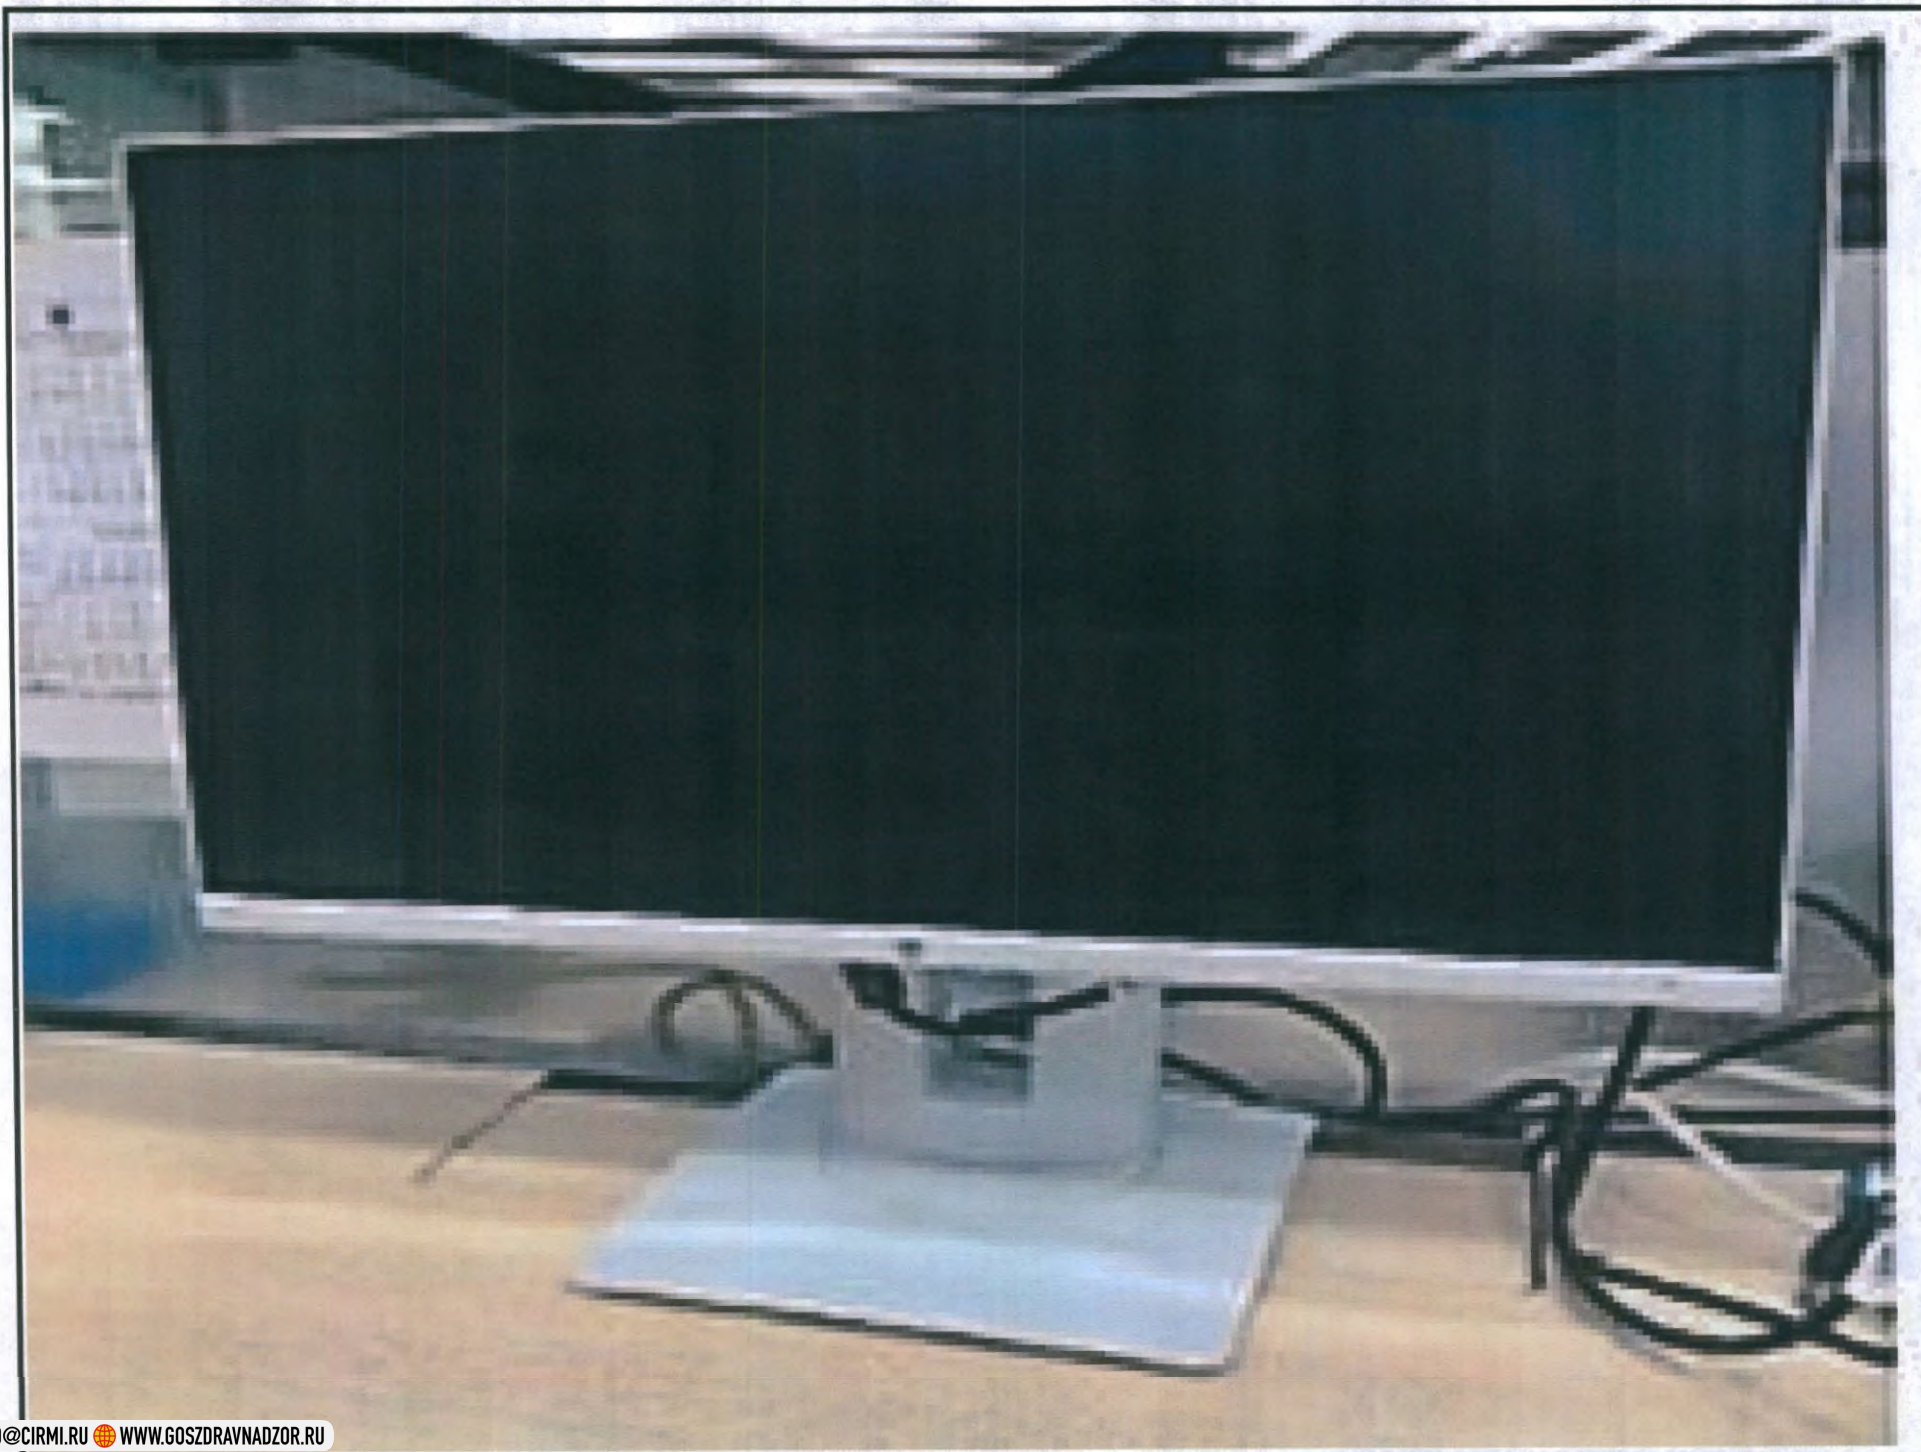

9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).





GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.
NO. 266 JINGSAN ROAD
TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308

REF

6433266-1: SIGMA Explorer

SN



1: 73A/200V3~, 50/60Hz
2: 70A/208V3~, 50/60Hz
3: 38A/380V3~, 50/60Hz
4: 37A/400V3~, 50/60Hz
5: 35A/415V3~, 50/60Hz
6: 31A/480V3~, 50/60Hz



MADE FOR



GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.

NO. 266 JINGSAN ROAD

TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA

TIANJIN, P.R. CHINA 300308

ASSEMBLED IN US

GE Healthcare Manufacturing LLC

3001 West Radio Drive

Florence, SC 29501 USA

REF

6433266-1: SIGNA Explorer

SN



1: 73A/200V3~, 50/60Hz 4: 37A/400V3~, 50/60Hz

2: 70A/208V3~, 50/60Hz 5: 35A/415V3~, 50/60Hz

3: 38A/380V3~, 50/60Hz 6: 31A/480V3~, 50/60Hz




GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED.
NO. 266 JINGSAN ROAD
TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308



GE Healthcare Manufacturing LLC
3001 West Radio Drive
Florence, SC 29501 USA



6433266-1: SIGNA Explorer



1: 73A/200V3~, 50/60Hz	4: 37A/400V3~, 50/60Hz
2: 70A/208V3~, 50/60Hz	5: 35A/415V3~, 50/60Hz
3: 38A/380V3~, 50/60Hz	6: 31A/480V3~, 50/60Hz

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»
для GE Healthcare (Tianjin) Company Limited

Томограф магнитно-резонансный SIGNA Explorer

REF XXXXXXXXXXXXX

SN XXXXXXXXXXXXX

 XX.XX.XXXX

EAC



38 A, 380 В 3 ~, 50 Гц,
37 A, 400 В 3 ~, 50 Гц,
35 A, 415 В 3 ~, 50 Гц

Сделано в России

XXXXXXXXX


II. Томограф магнитно-резонансный SIGNA Explorer:




1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.




1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

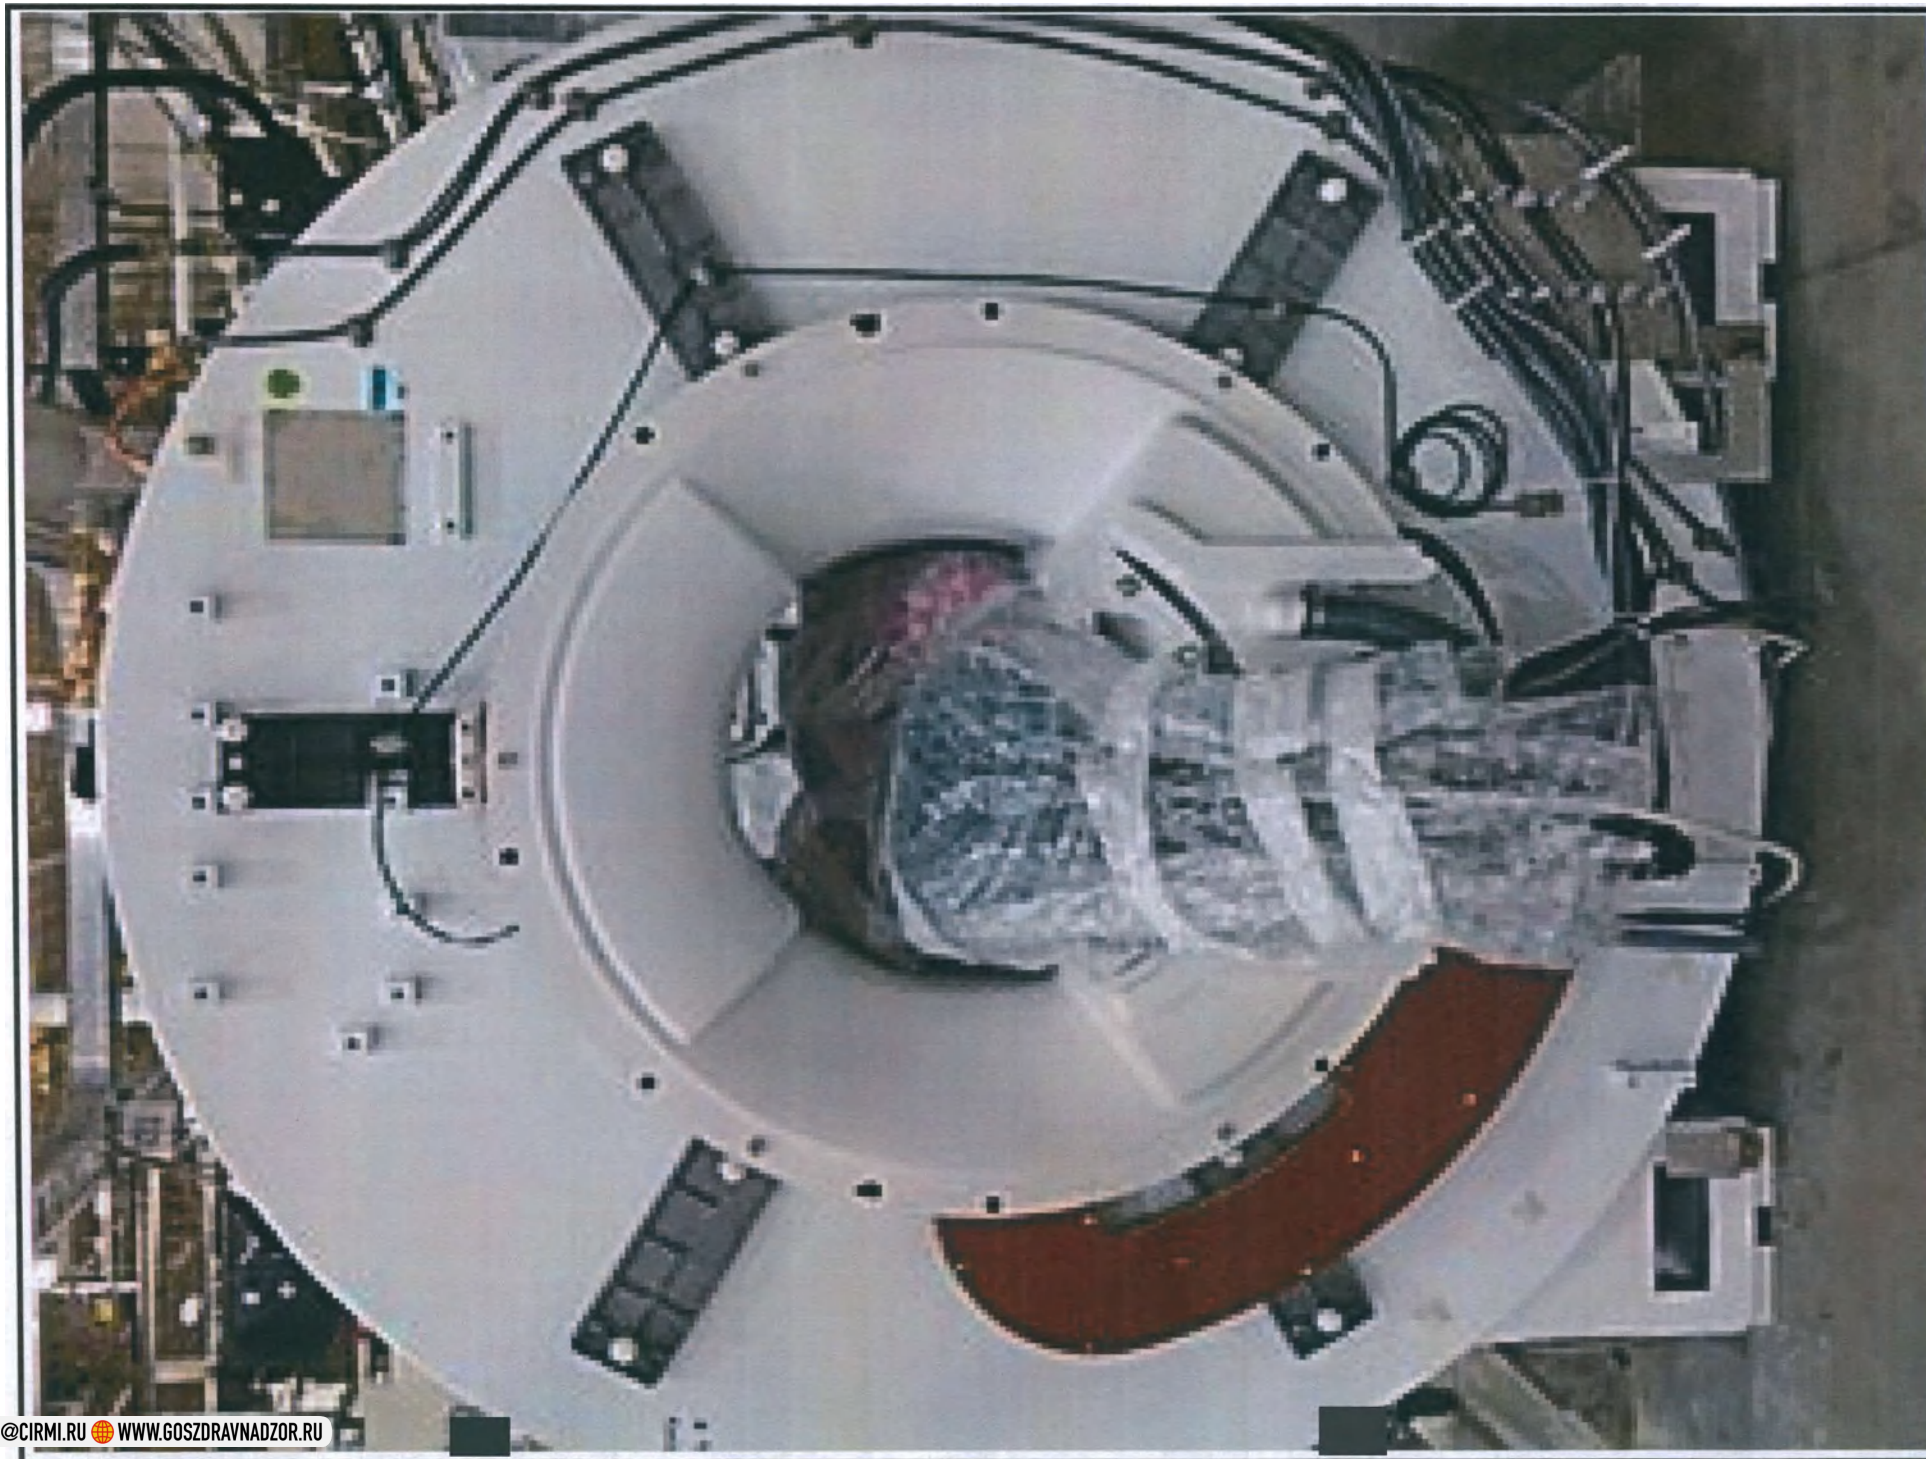


1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

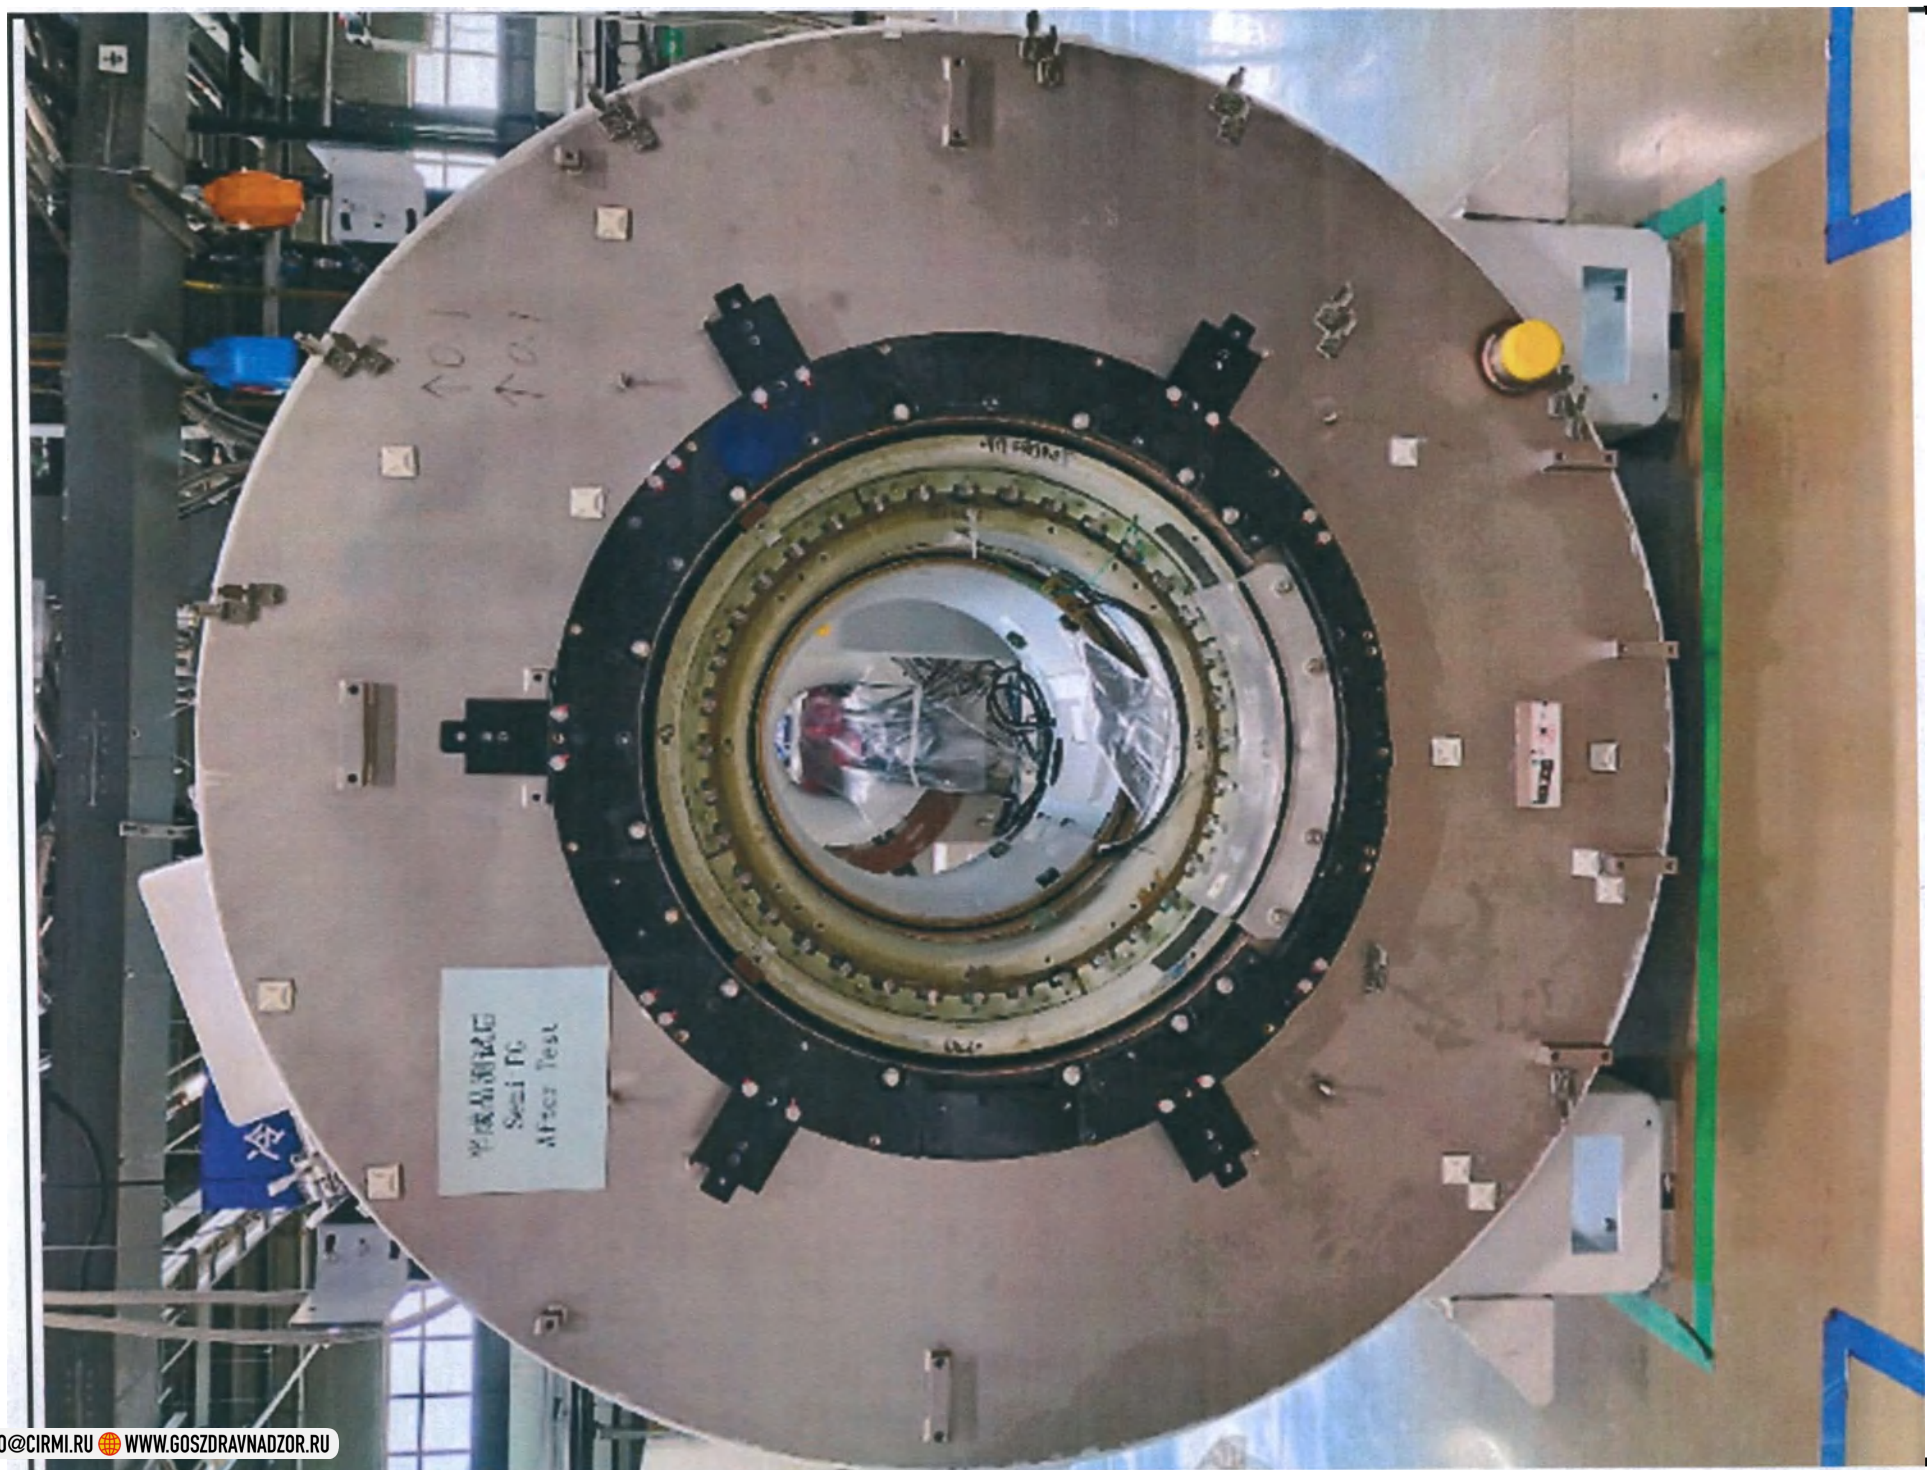


1. Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой.

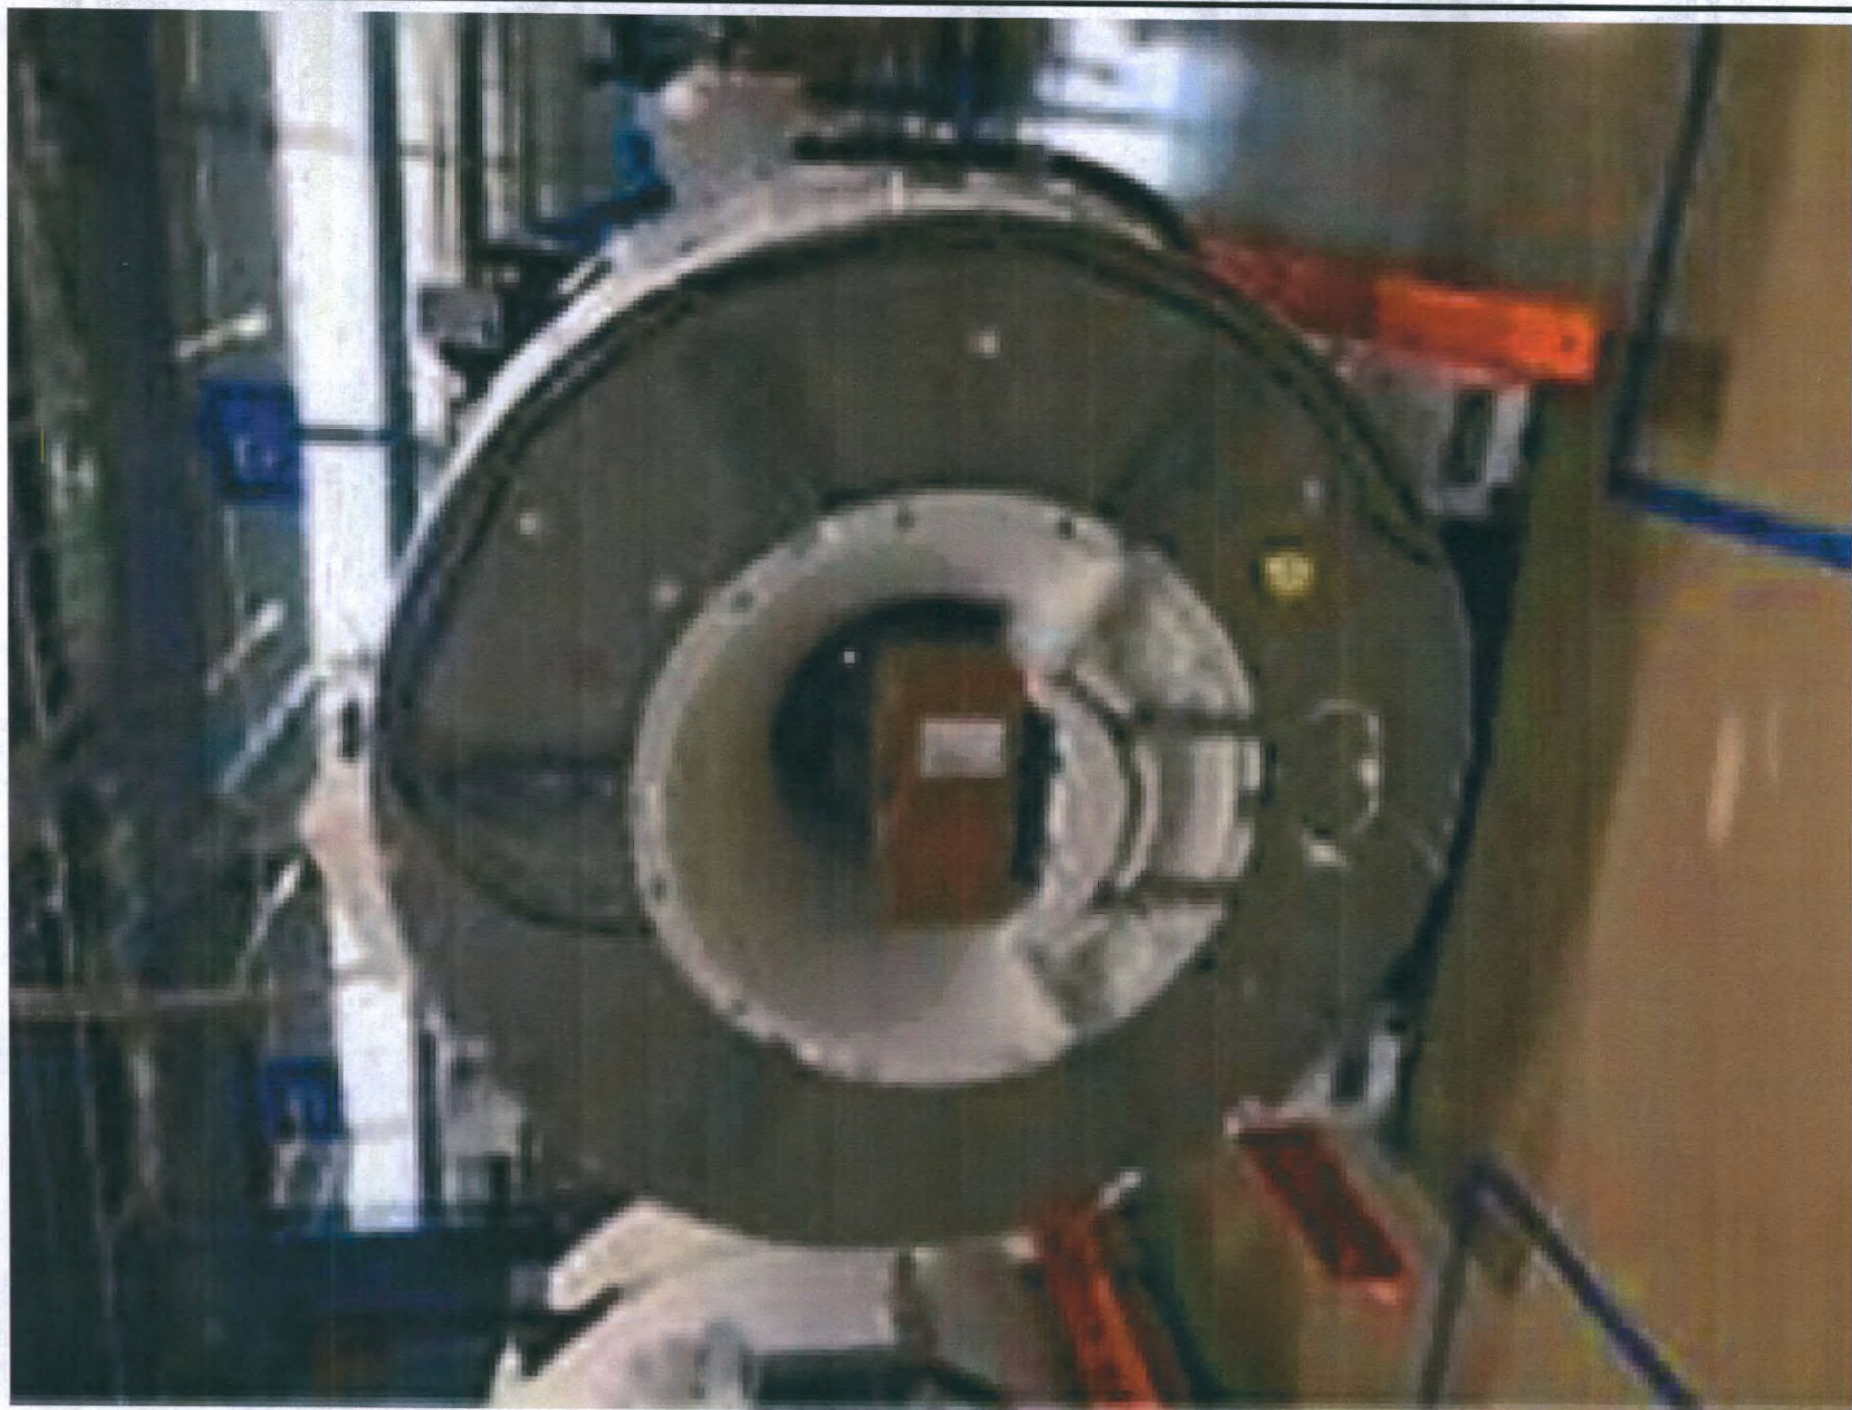

2. Консоль оператора для ручного управления сканированием, расположенным на передней панели магнита.

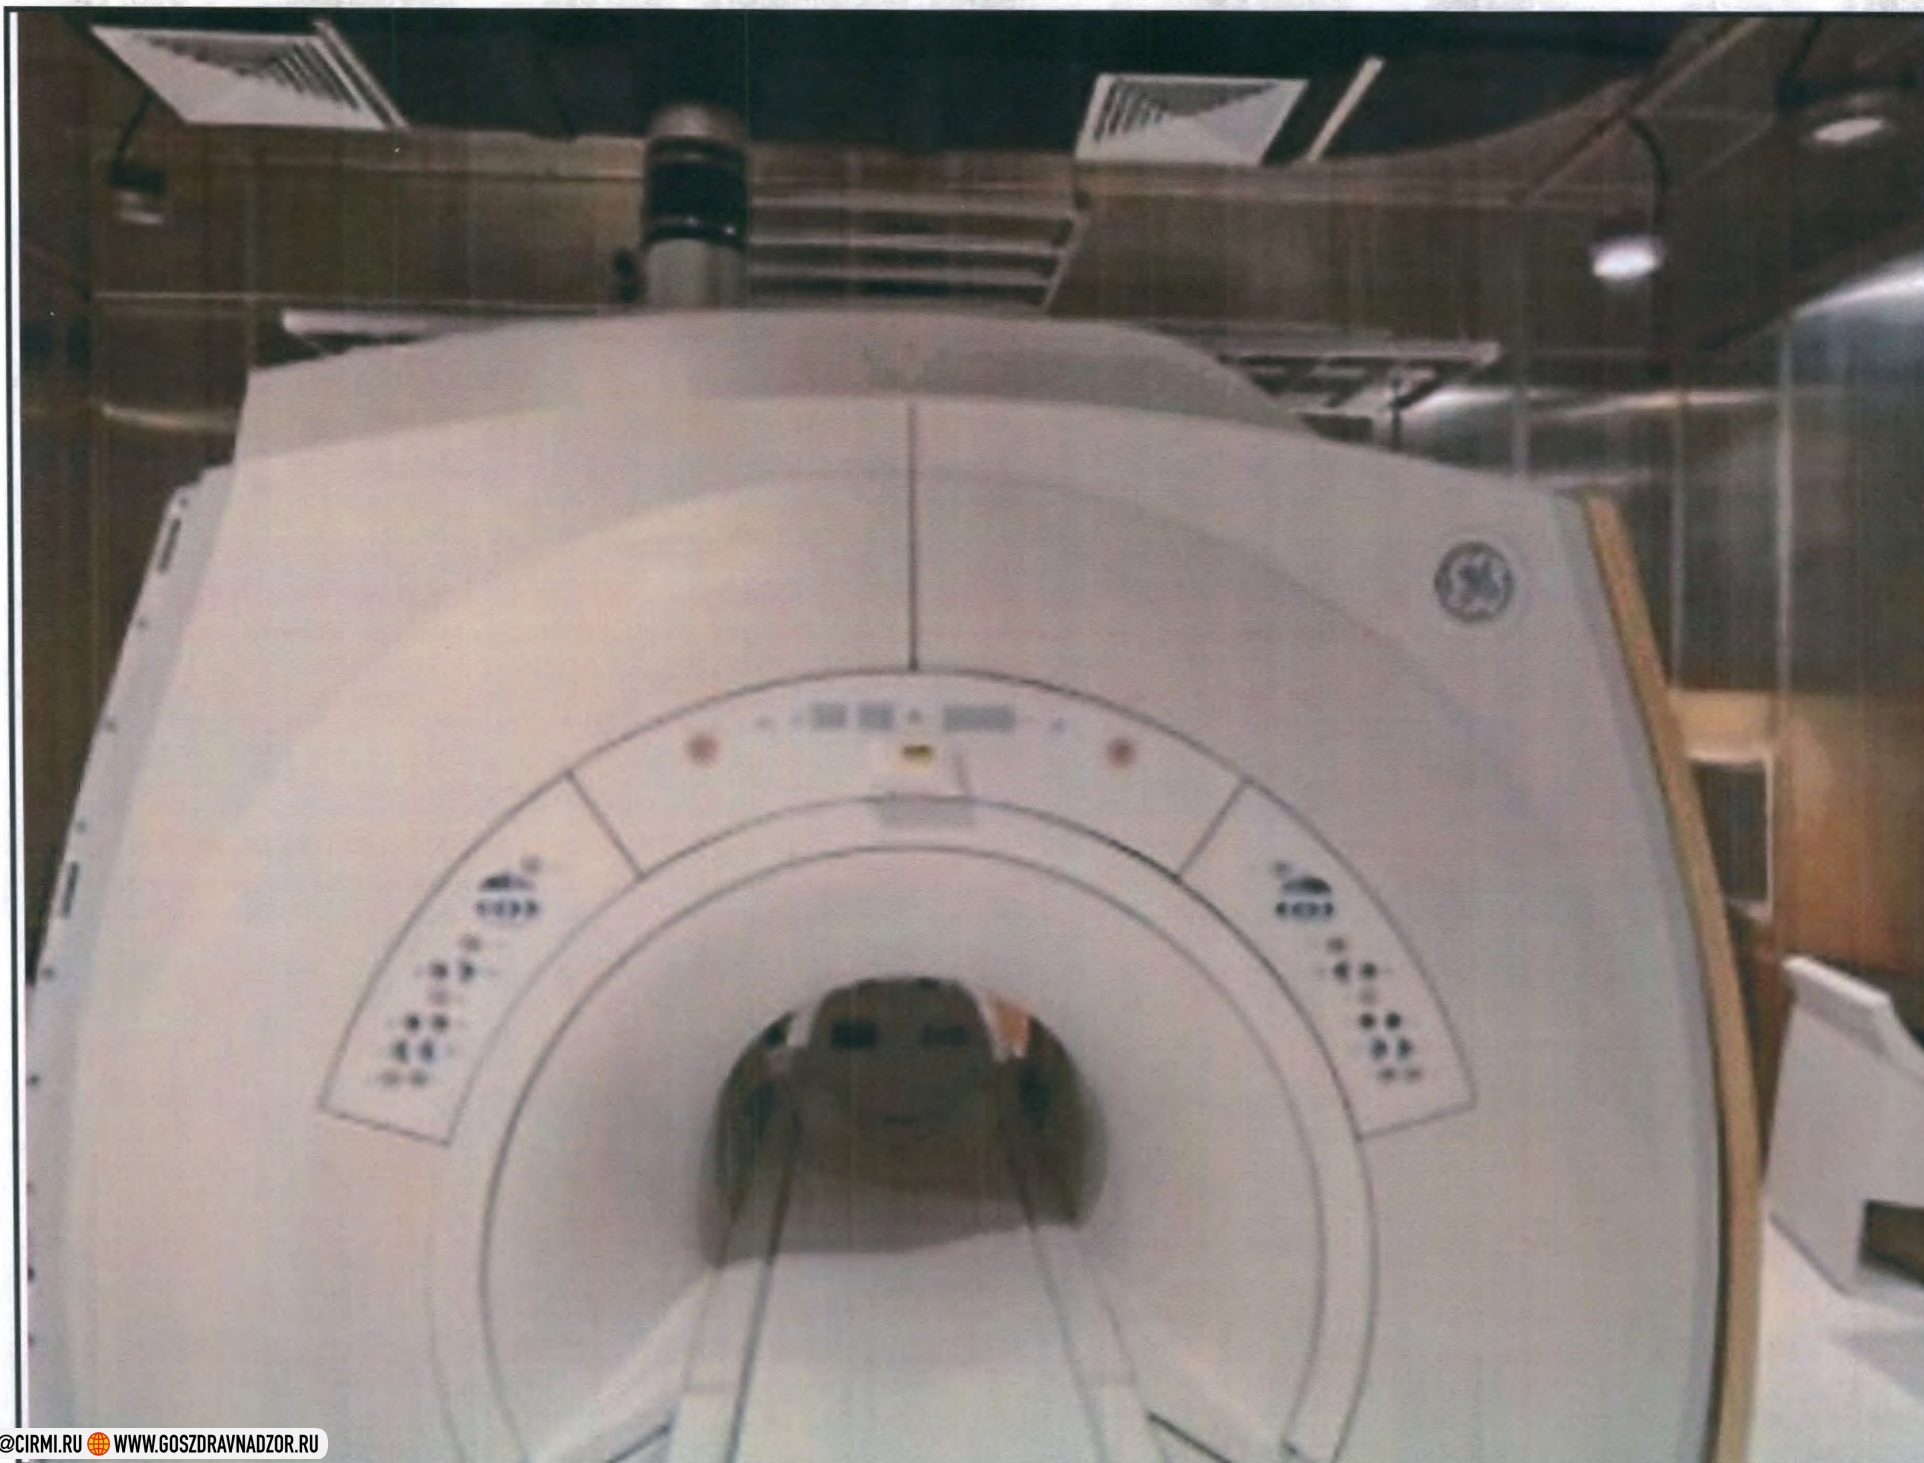


3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).

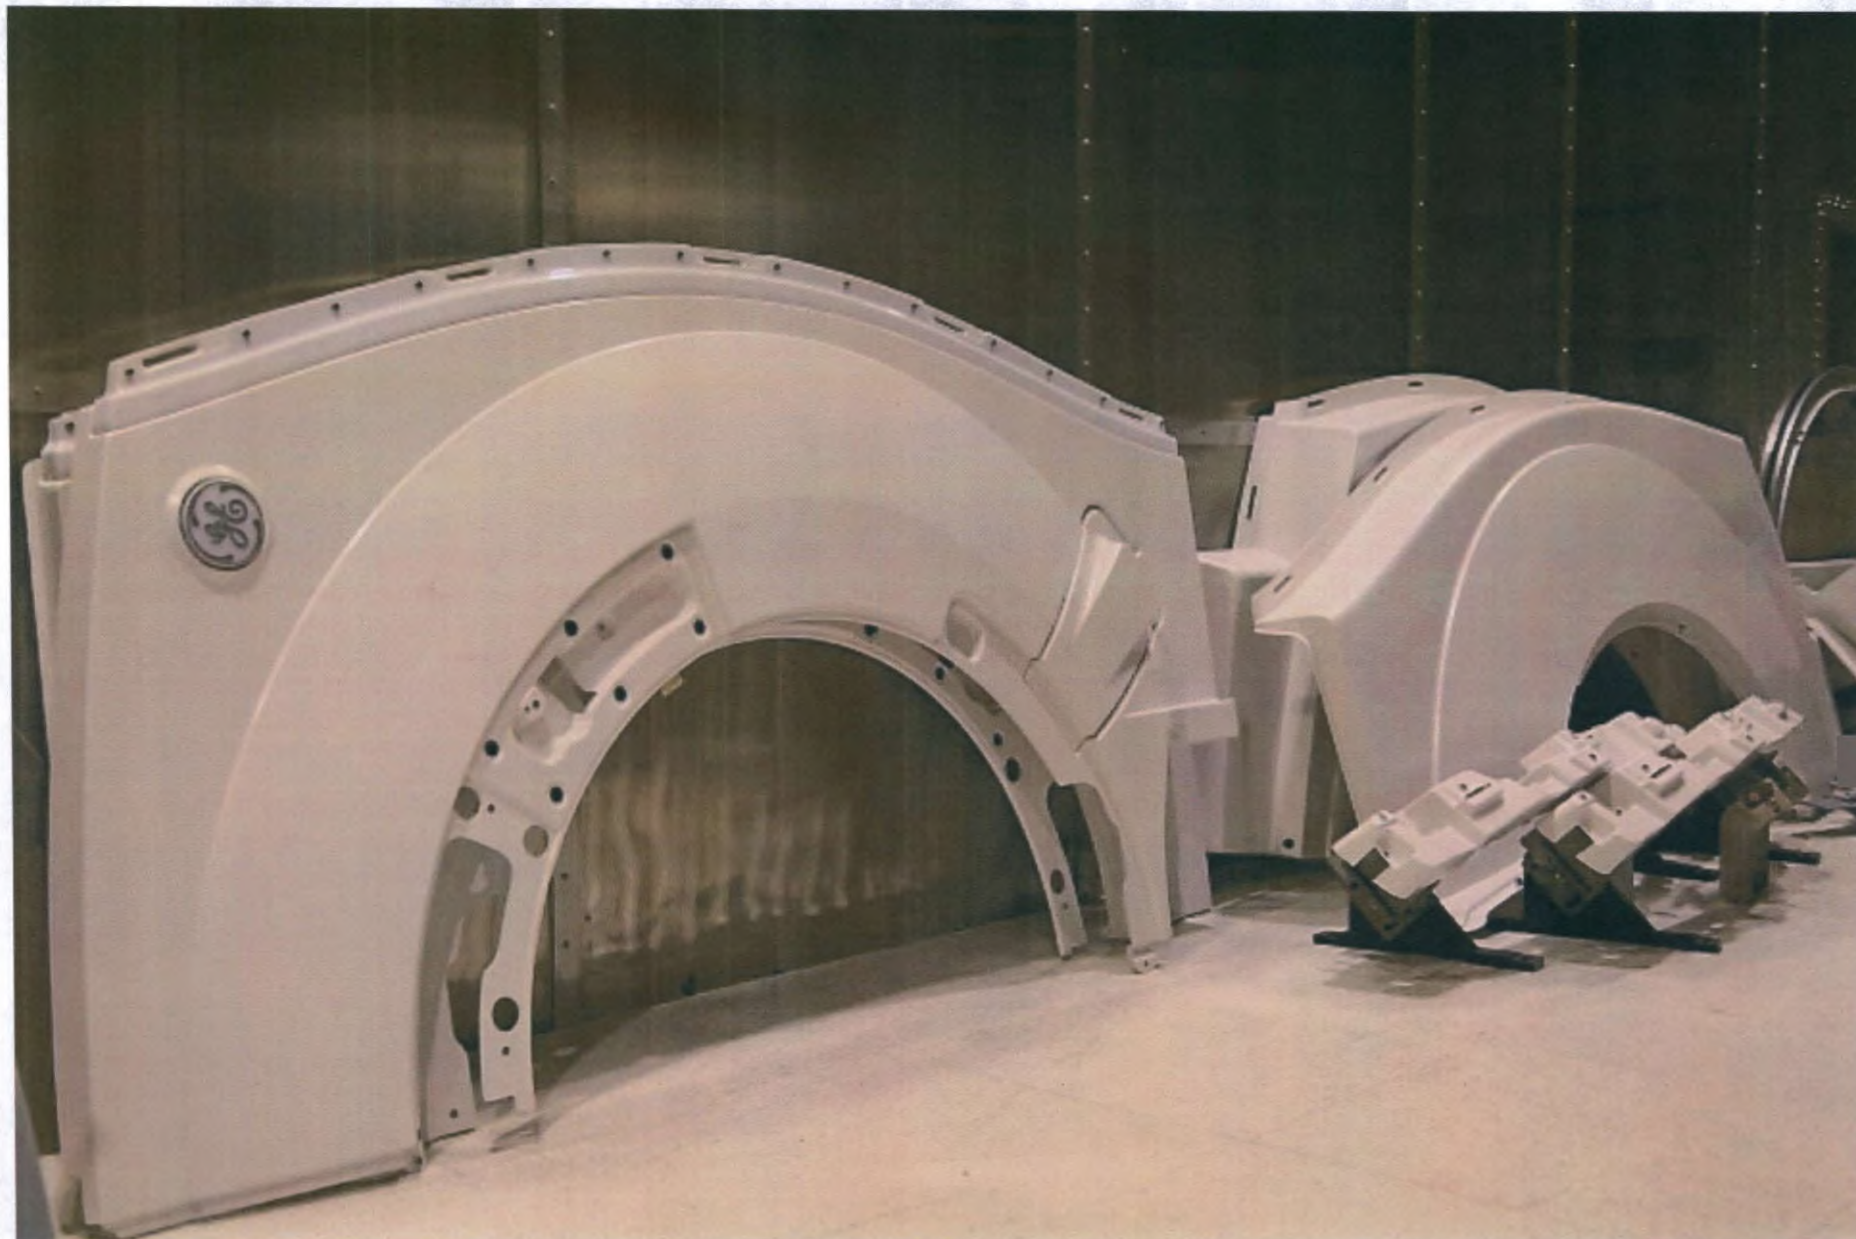


3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).



3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).

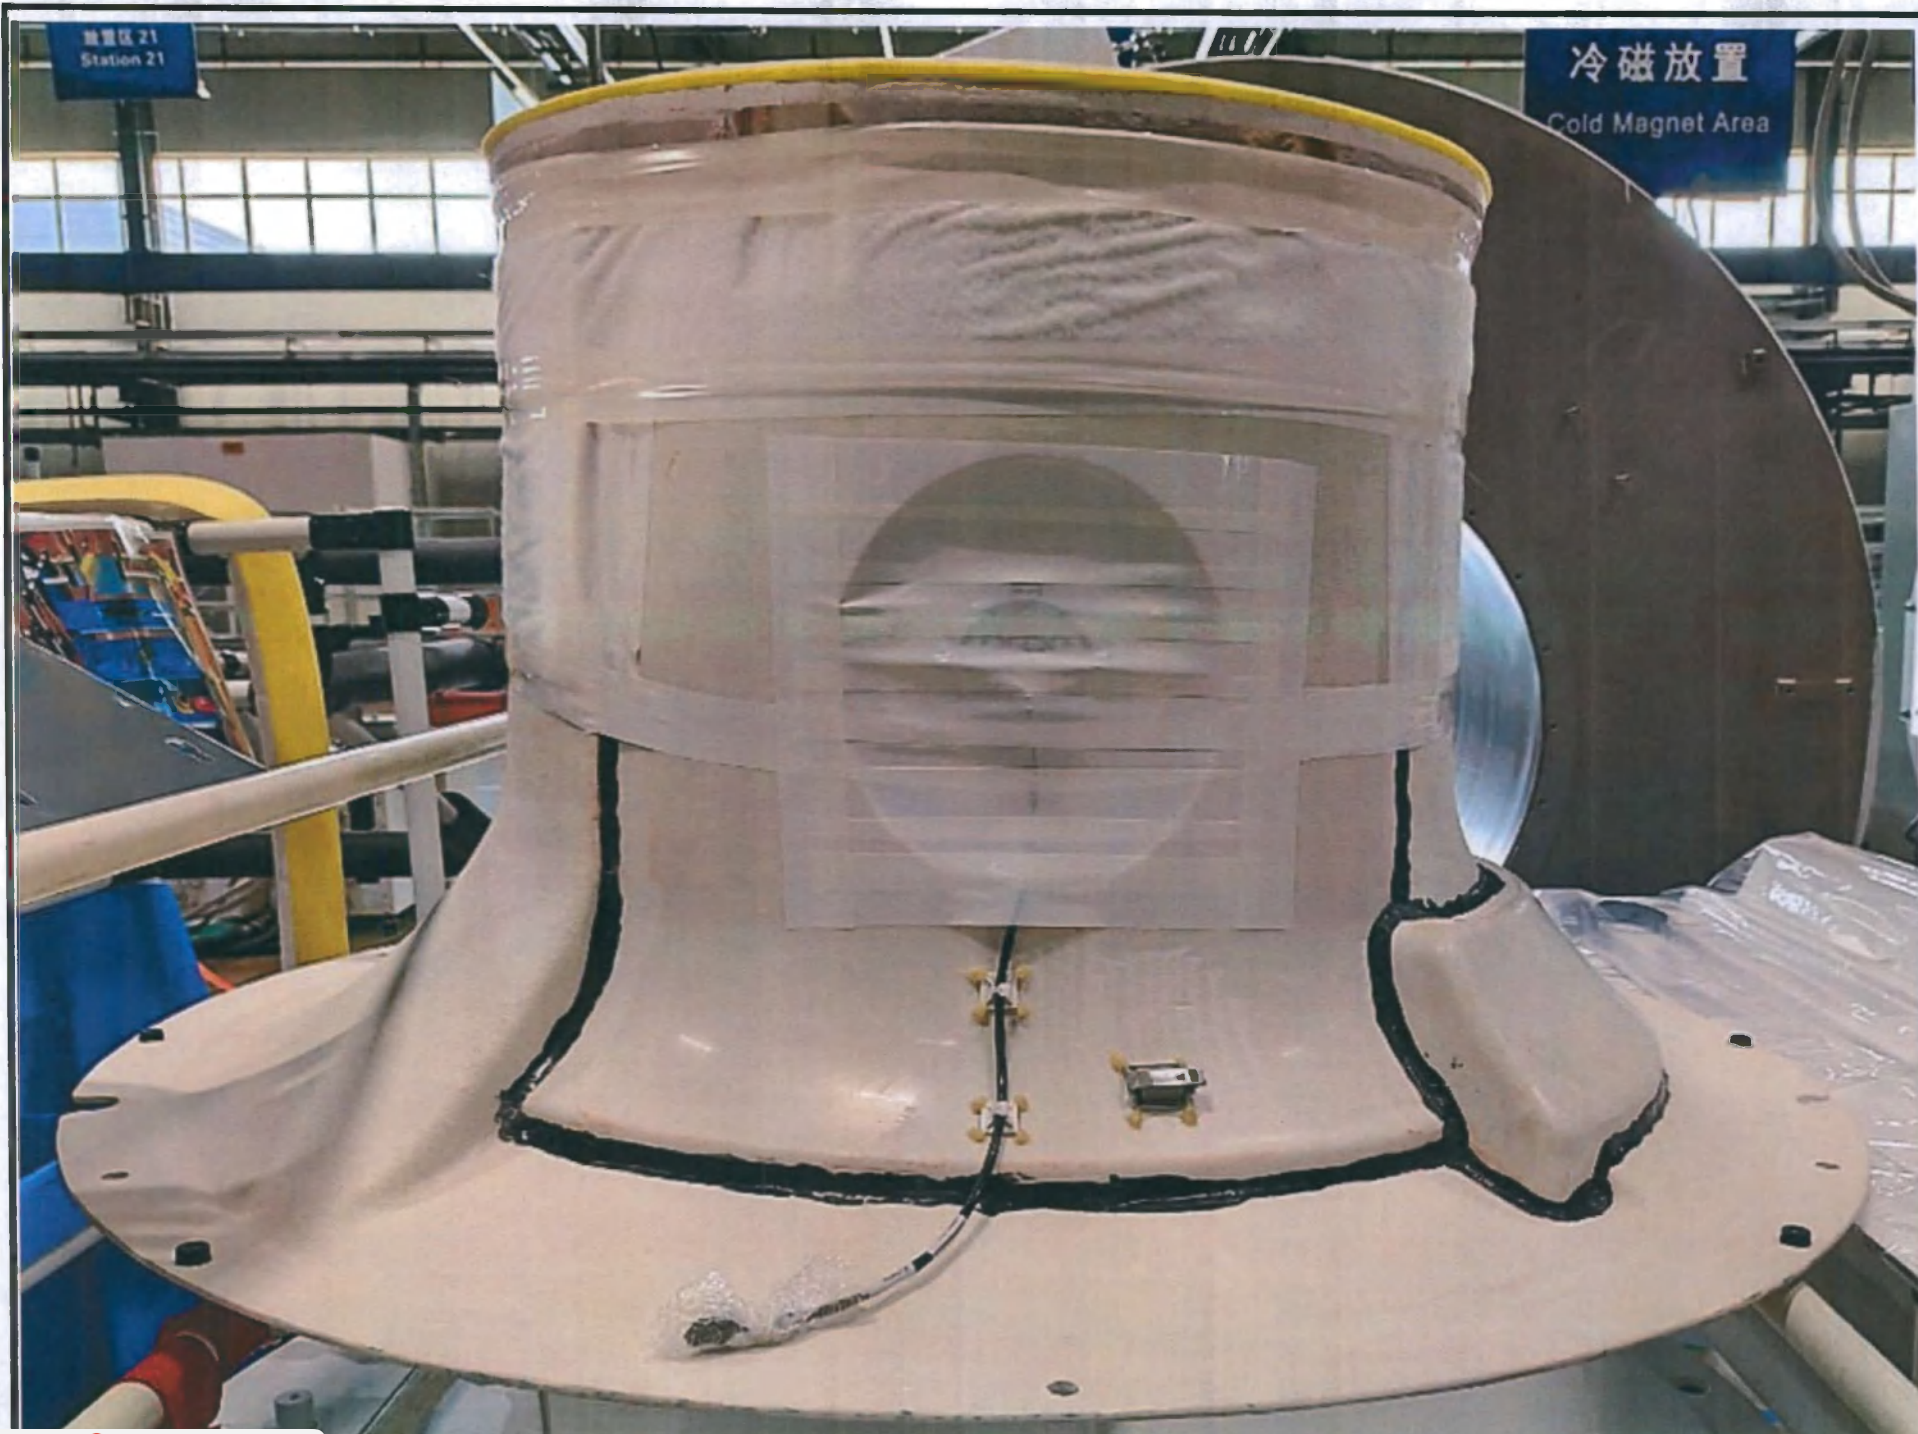


3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).

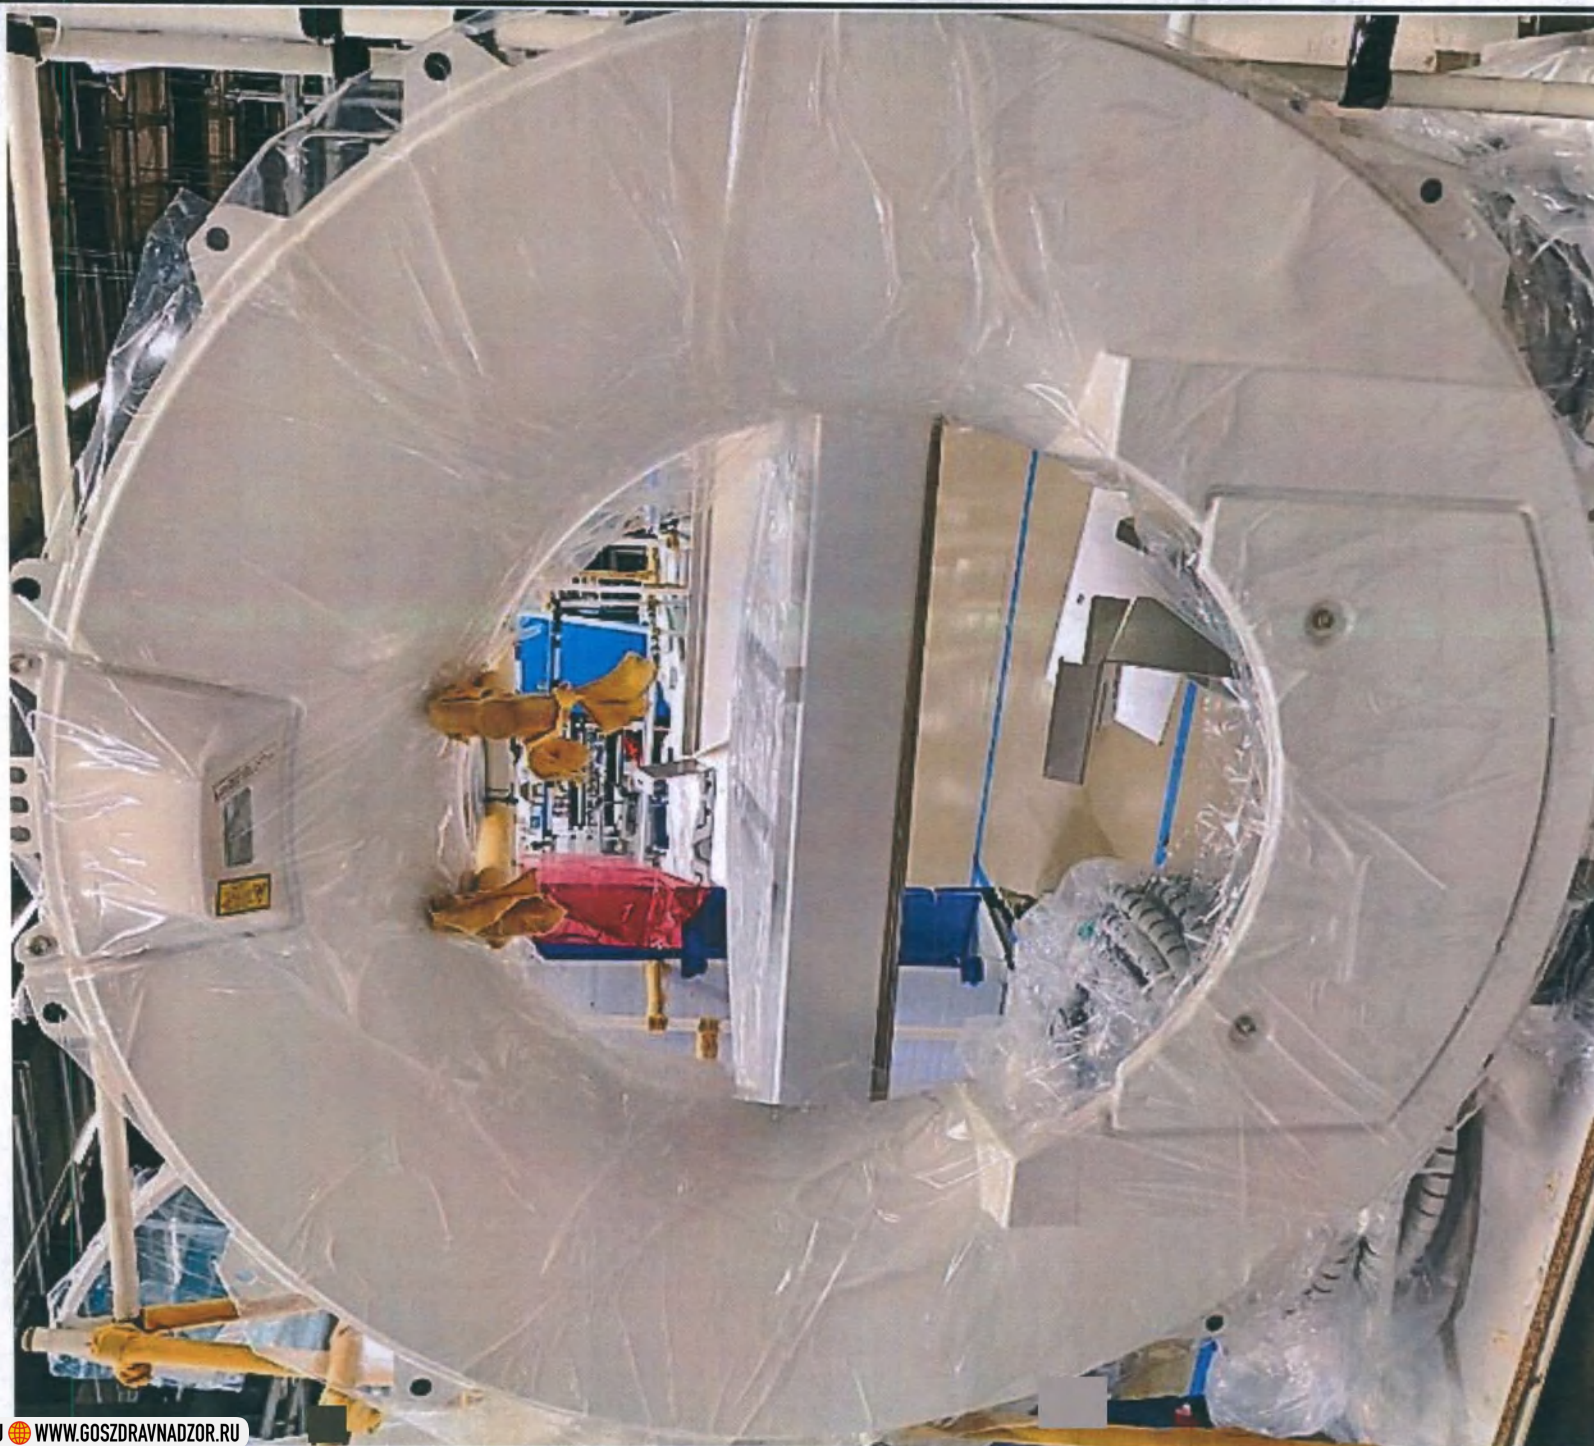

3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).



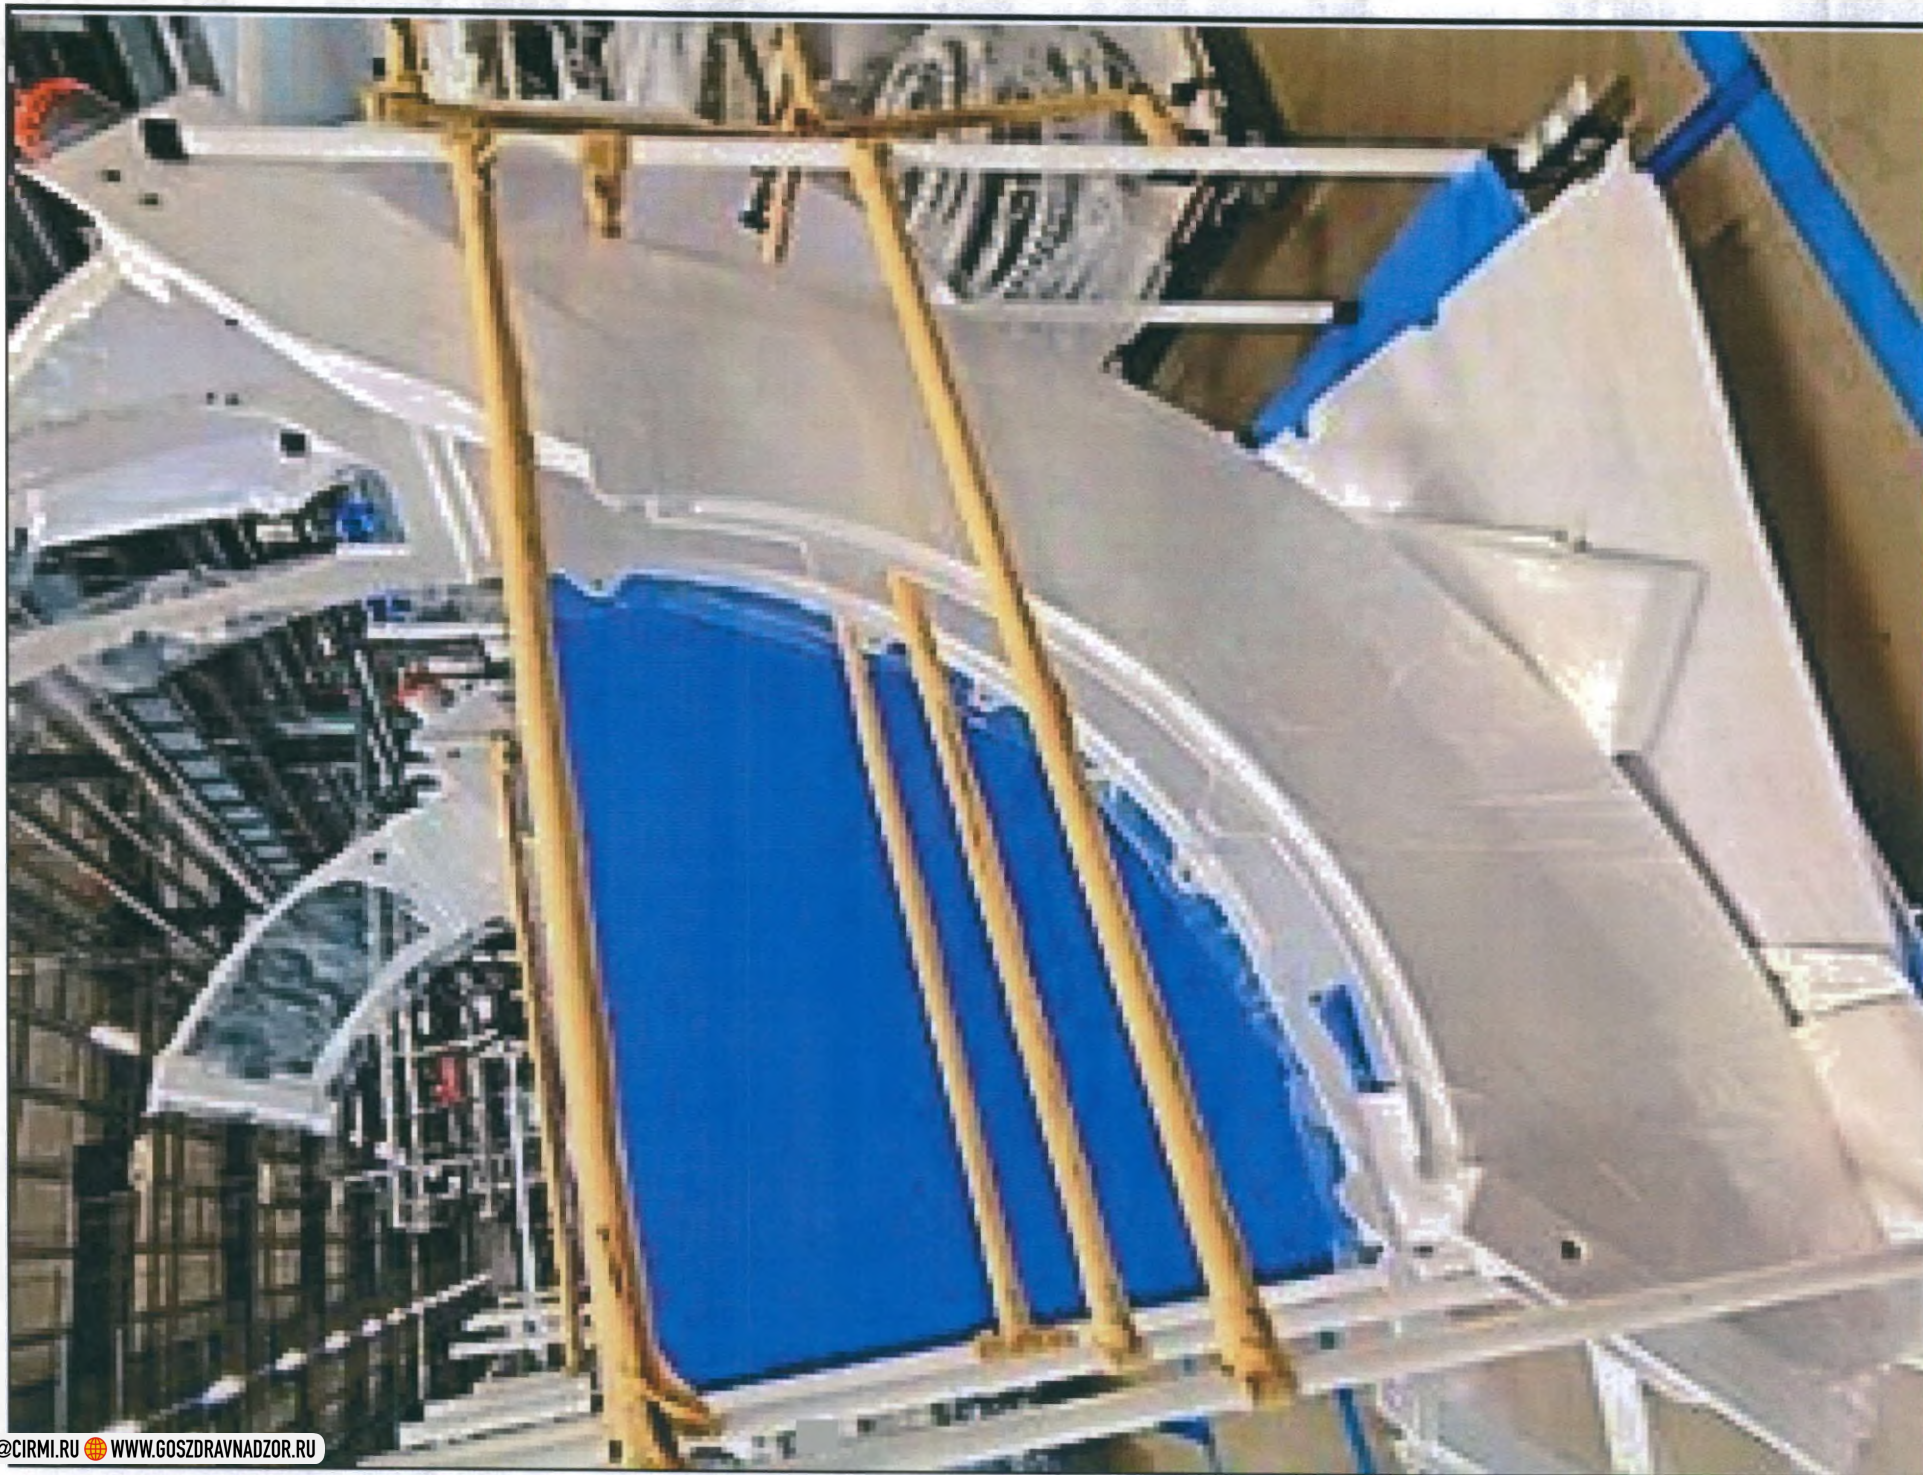

3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).



3. Кожухи магнита (не более 40 шт.).




4. Консоль оператора (не более 5 шт.).





5. Шкафы электроники основные (не более 10 шт.).

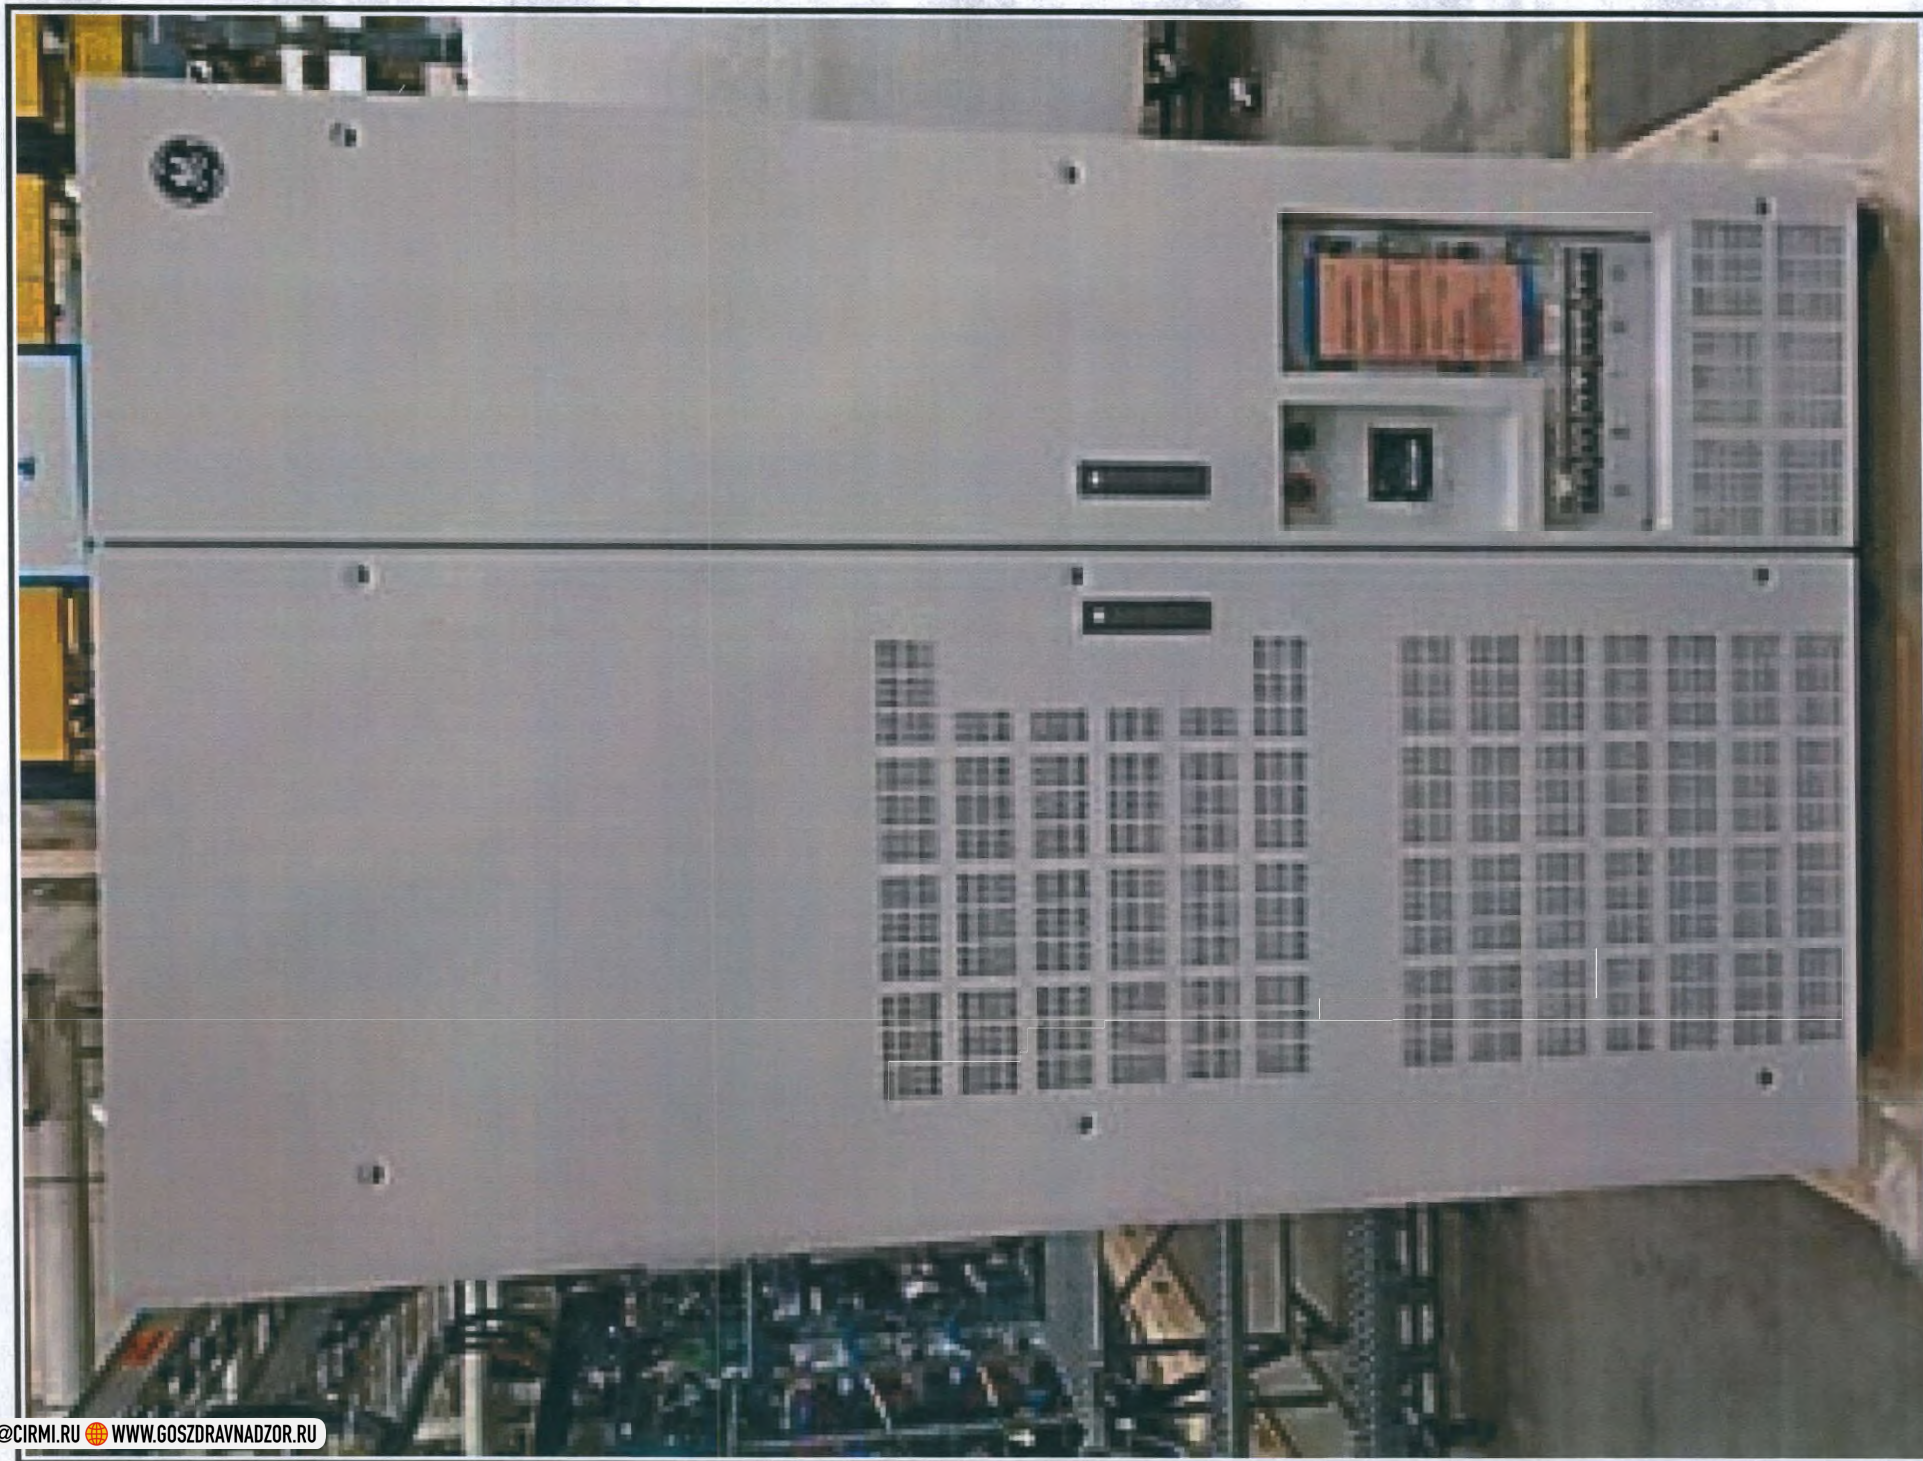

6. Стол пациента, варианты исполнения: Низкий фиксированный.



6. Стол пациента, варианты исполнения: Стандартный.




6. Стол пациента, варианты исполнения: Стол Lite.





7. Порт консоли катушки.



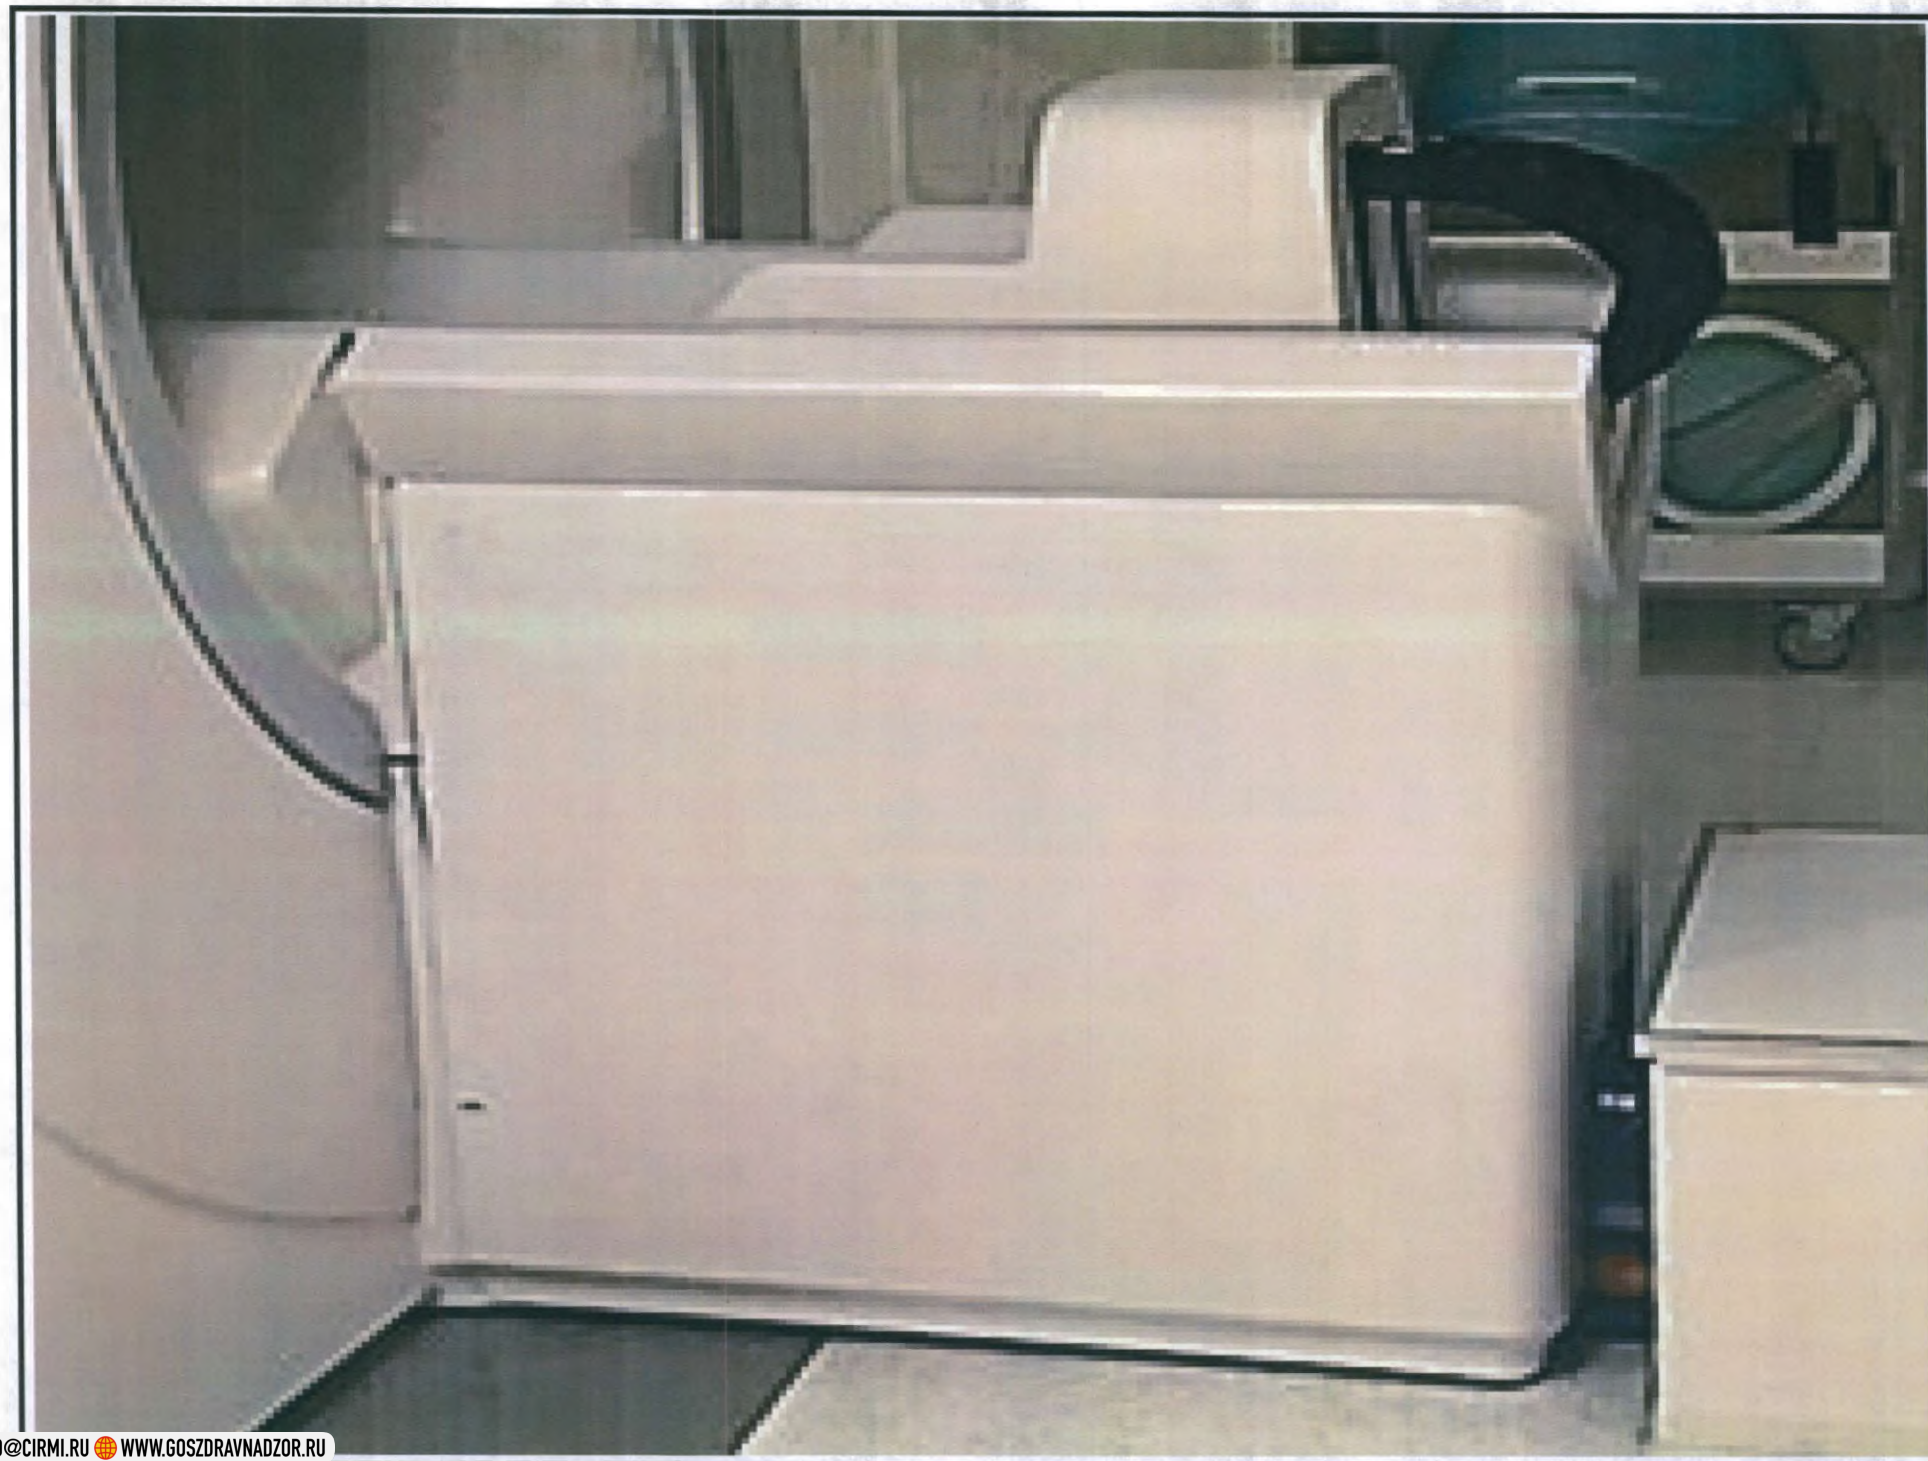

Томограф магнитно-резонансный SIGNA, варианты исполнения:

- SIGNA Creator,
- SIGNA Explorer

Руководство оператора

Этот документ является руководством оператора, общим для моделей SIGNA Creator и SIGNA Explorer. Имеющиеся функции, катушки и области применения будут различаться в зависимости от выбранной конфигурации системы. Дополнительную информацию по основам работы, а также скриншоты можно получить в учебной программе на английском языке.



Системы 1.5T MR

Руководство оператора, русский язык

6339011-299 на русском (07/2021) ред. 1

© 2021 General Electric Company

Все права защищены.

SIGNA Creator SIGNA Explorer Магнитно-резонансная система 1.5T

Руководство оператора



Этот документ является руководством оператора, общим для моделей SIGNA Creator и SIGNA Explorer. Имеющиеся функции, катушки и области применения будут различаться в зависимости от выбранной конфигурации системы. Дополнительную информацию по основам работы, а также скриншоты можно получить в учебной программе на английском языке.



Системы 1.5T MR

Руководство оператора, русский язык

6339001-299 на русском (2021-06) ред. 2

© 2021 General Electric Company


Все права защищены.

8. Руководства пользователя (не более 5 шт.).






9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).

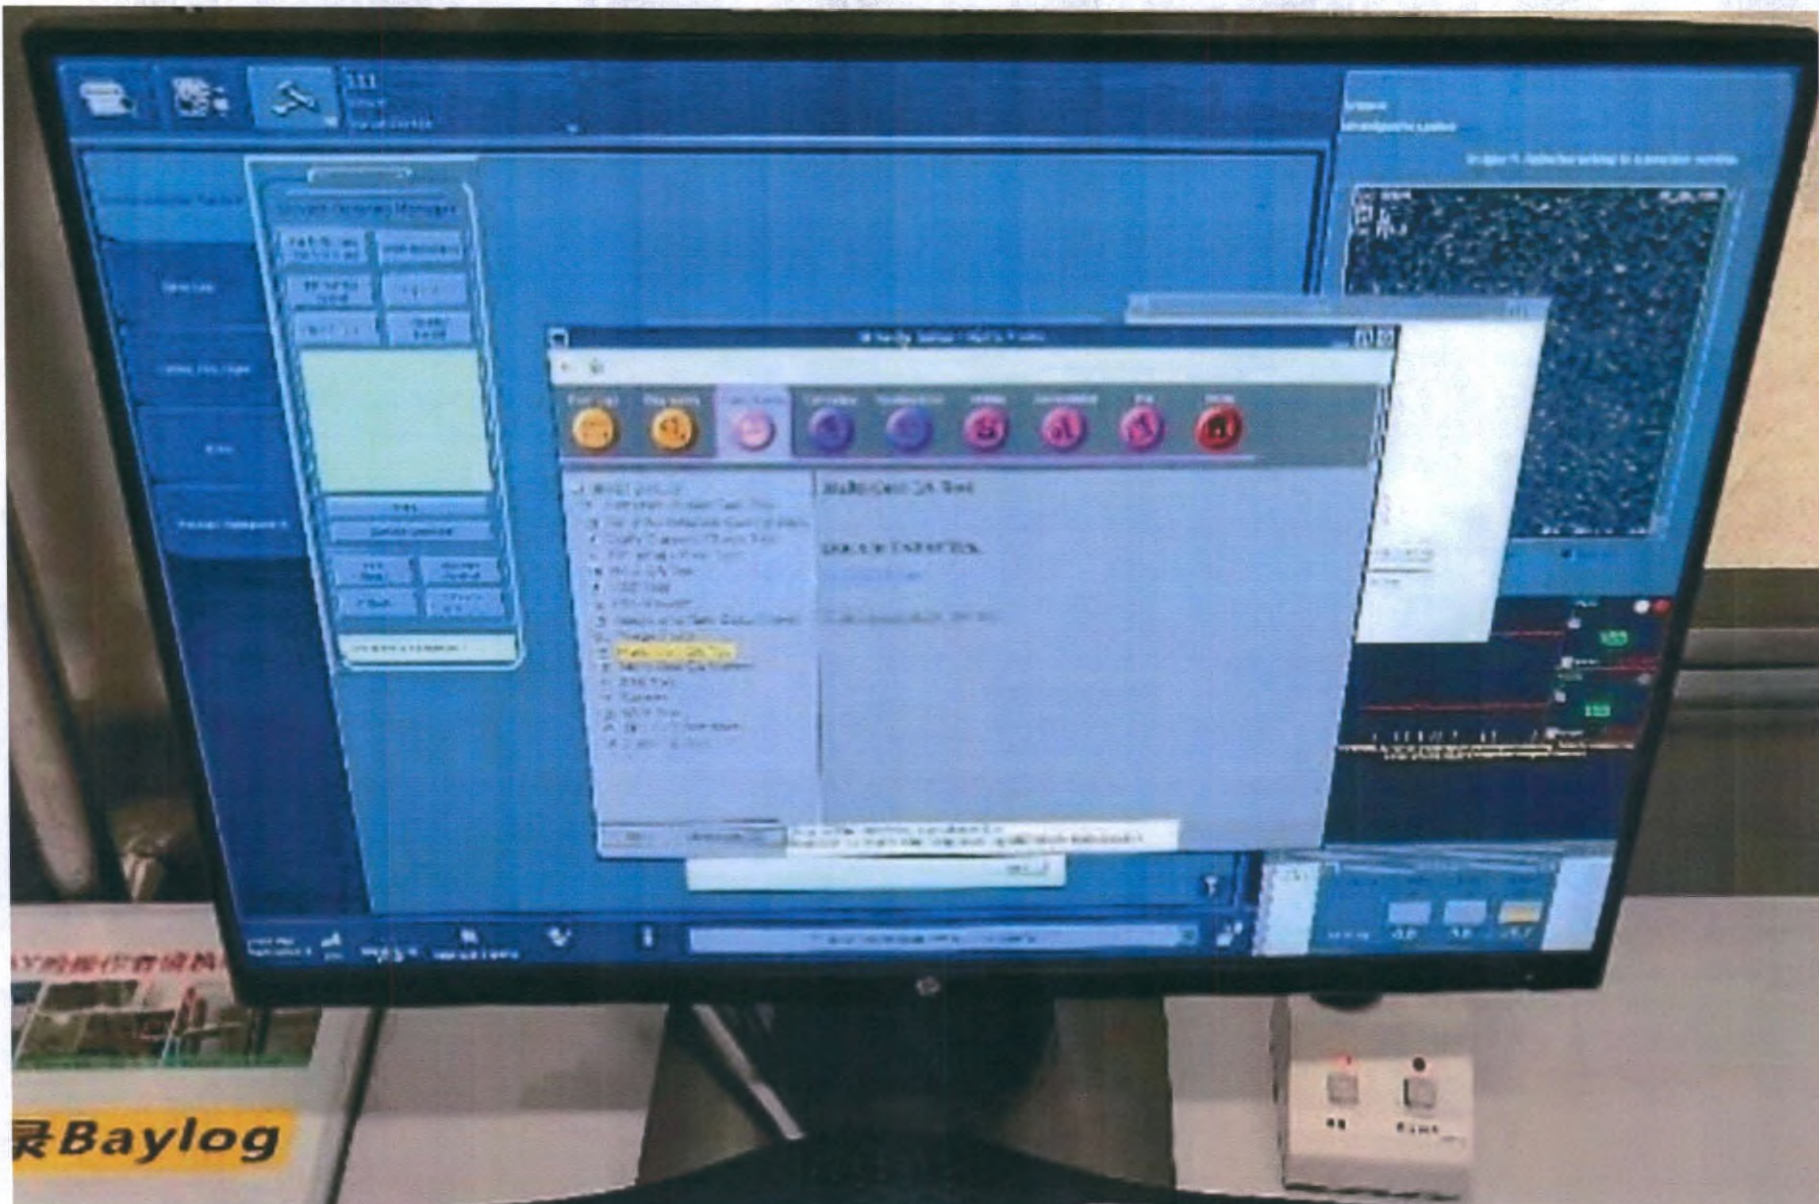

9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).

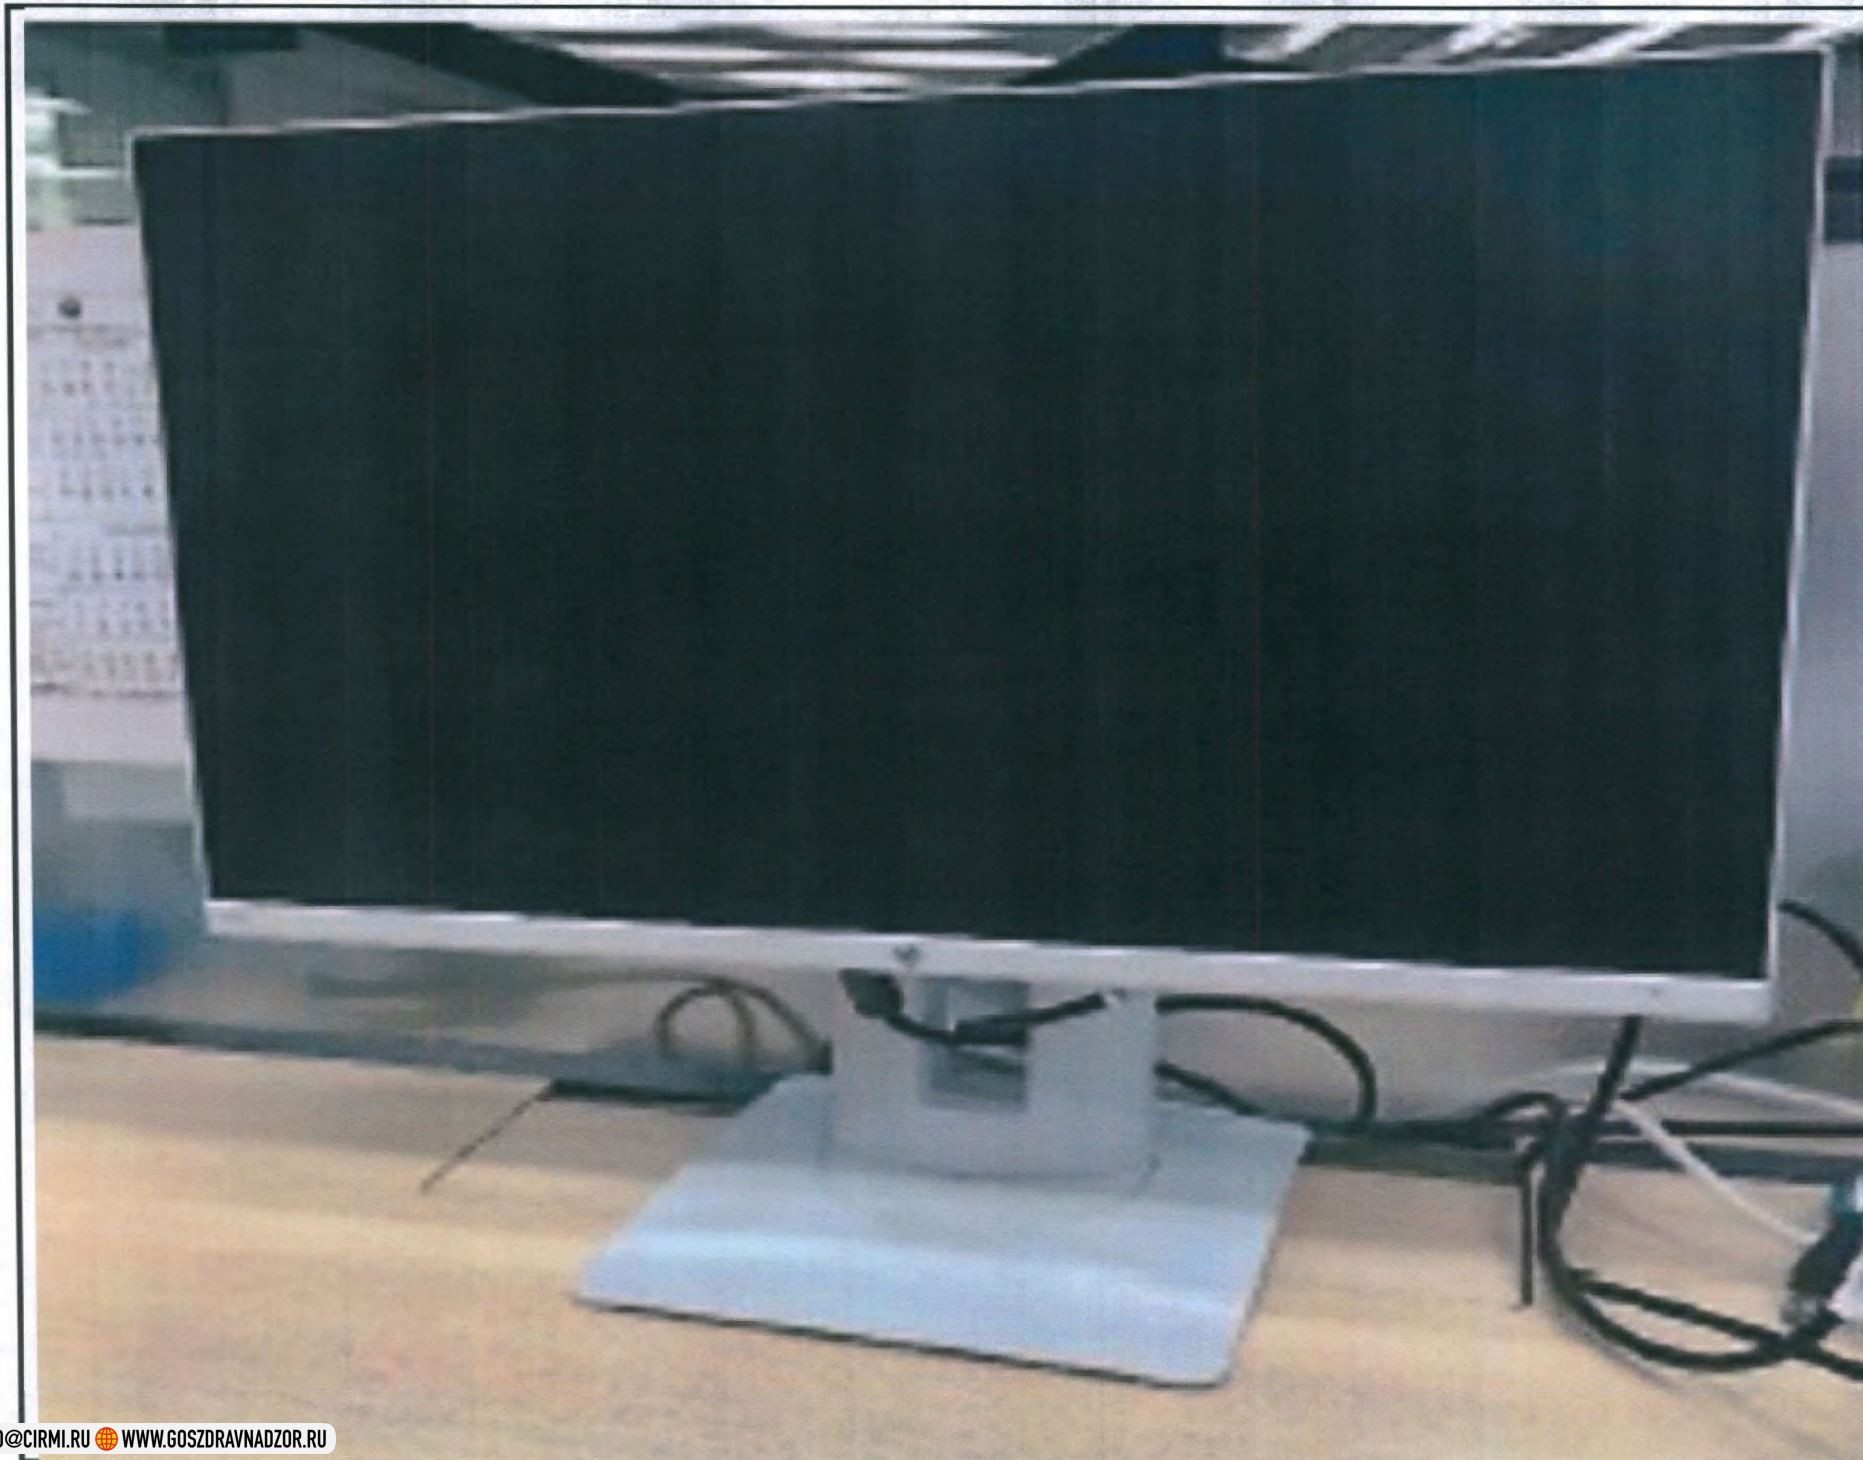


9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).



9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).

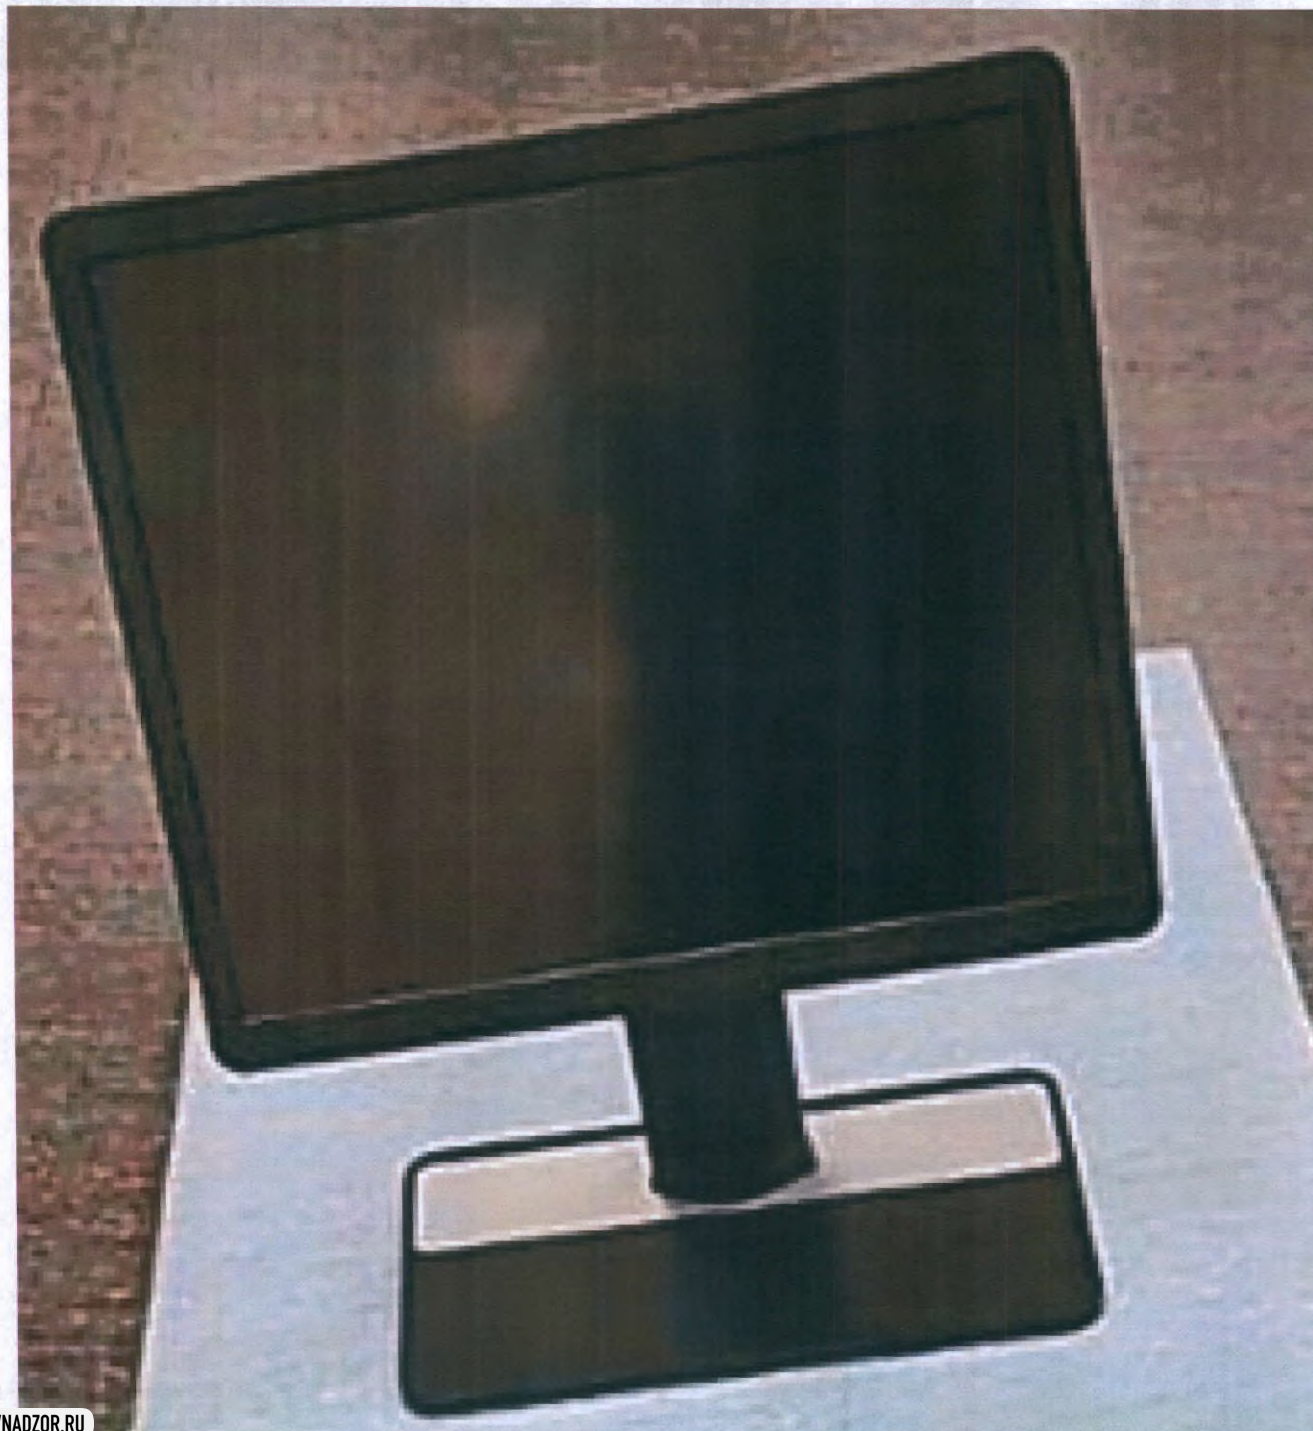

9. Мониторы консоли оператора (не более 4 шт.).




III. Принадлежности: 1. Блок дистанционного отключения магнита (не более 5 шт.).




III. Принадлежности: 1. Блок дистанционного отключения магнита (не более 5 шт.).



2. Контроллер получения физиологических данных РАС (не более 5 шт.).

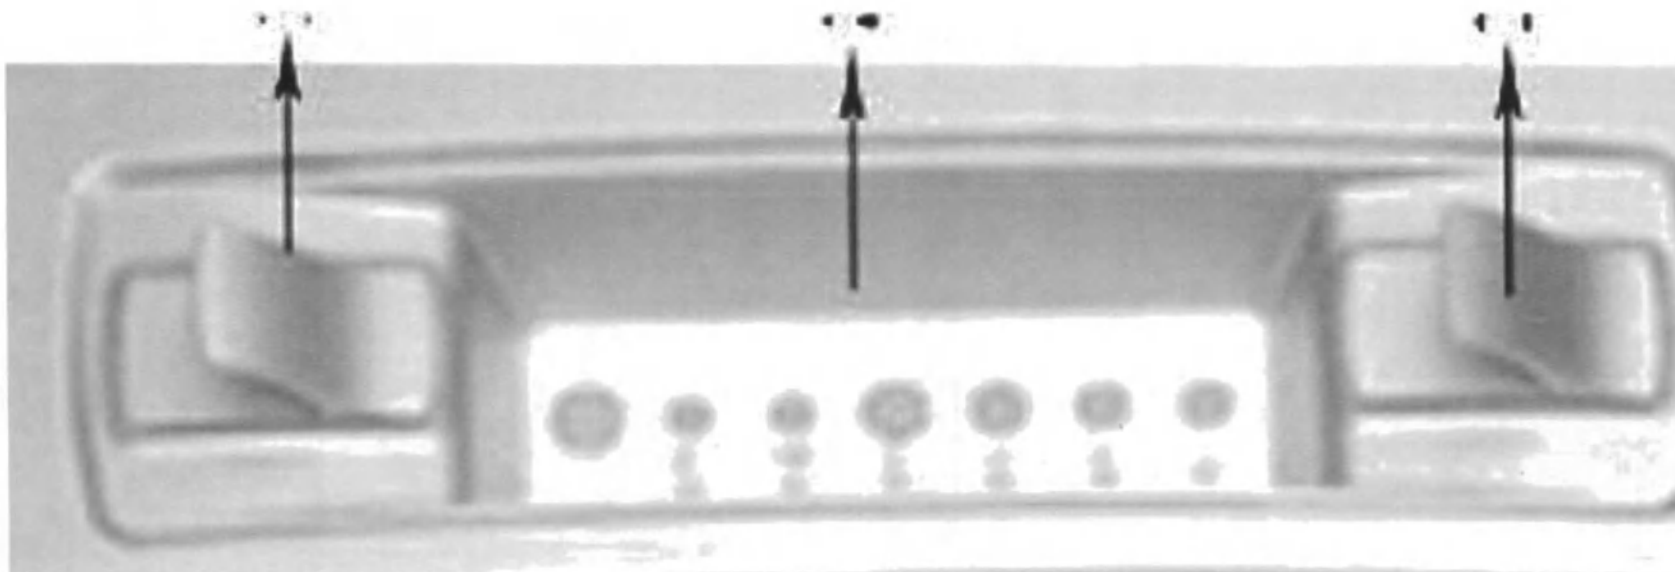


2. Контроллер получения физиологических данных РАС (не более 5 шт.).

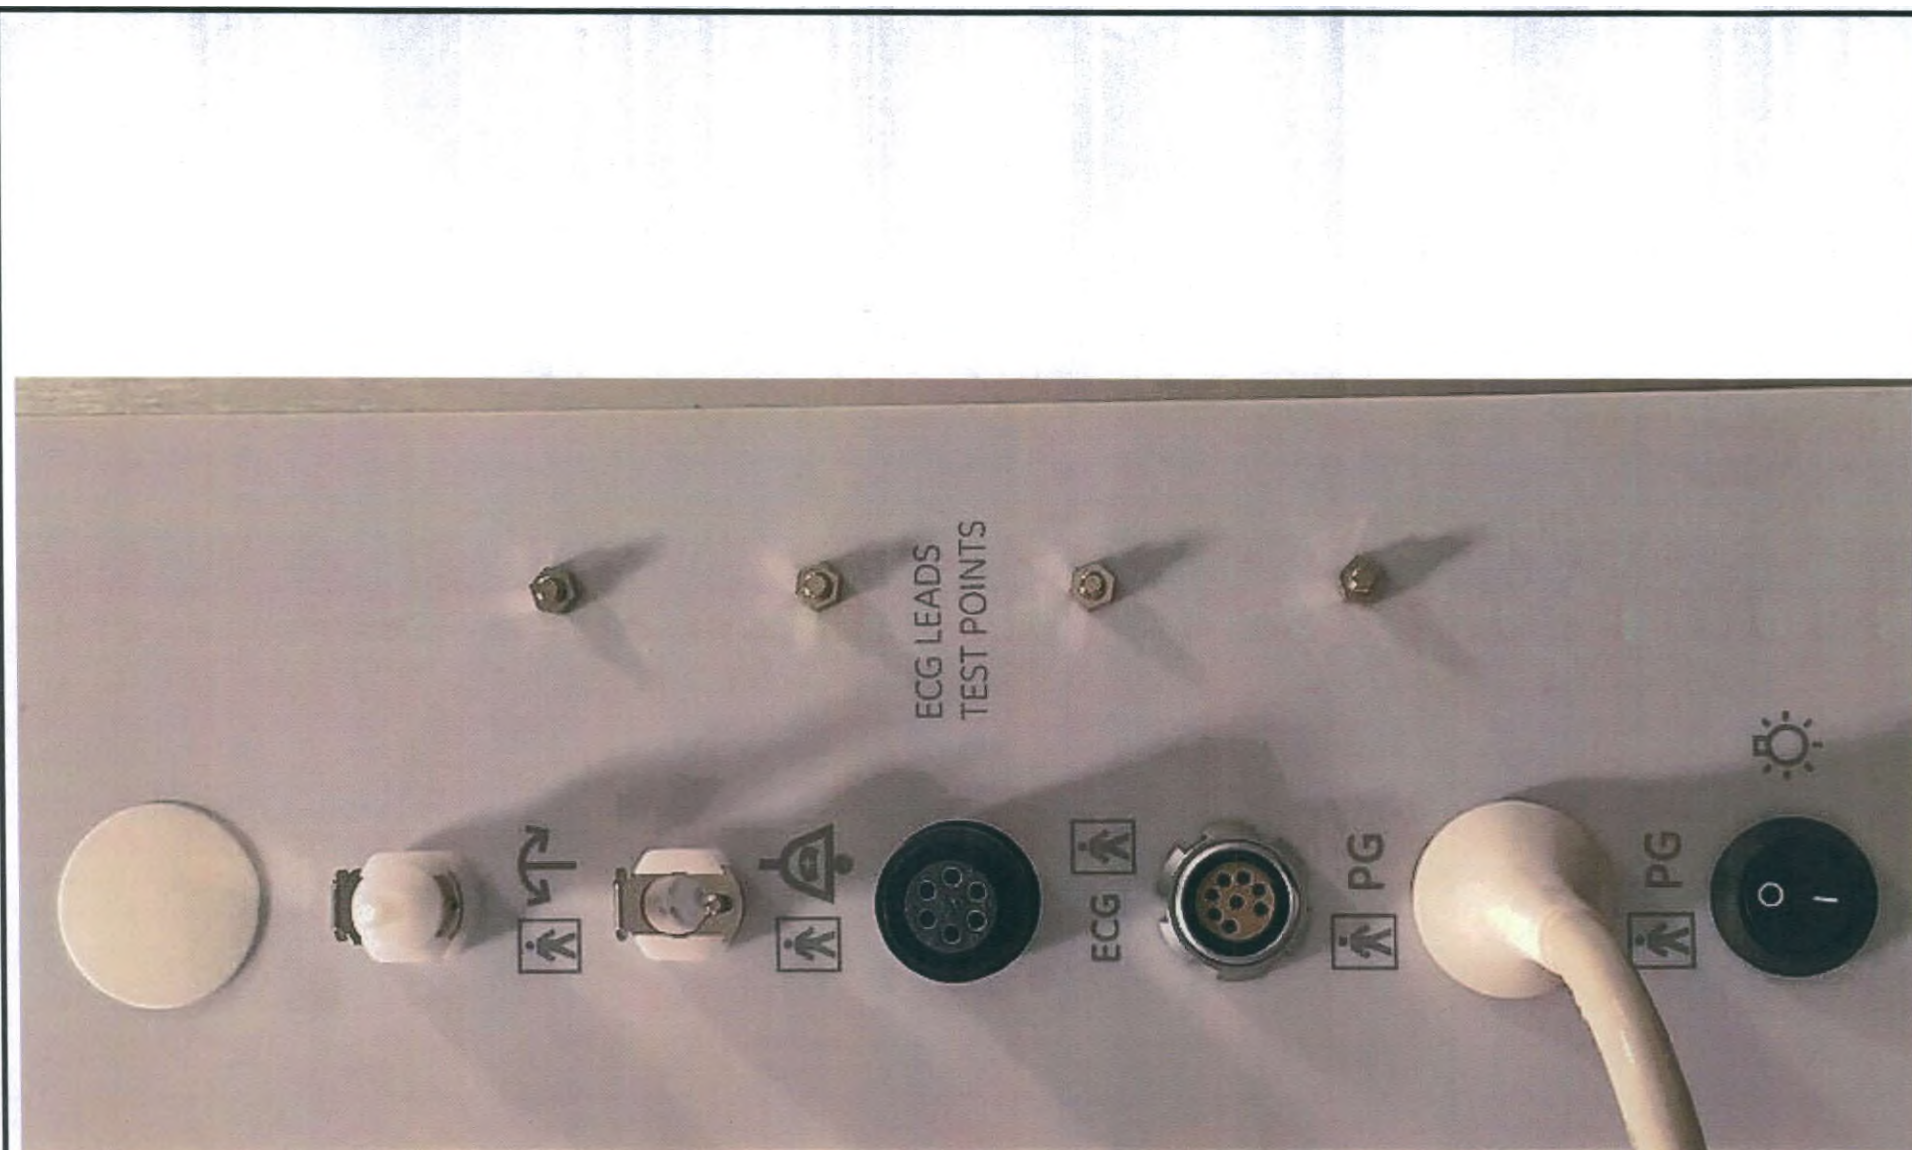

3. Стул оператора (не более 5 шт.).




4. Стол оператора (не более 5 шт.).

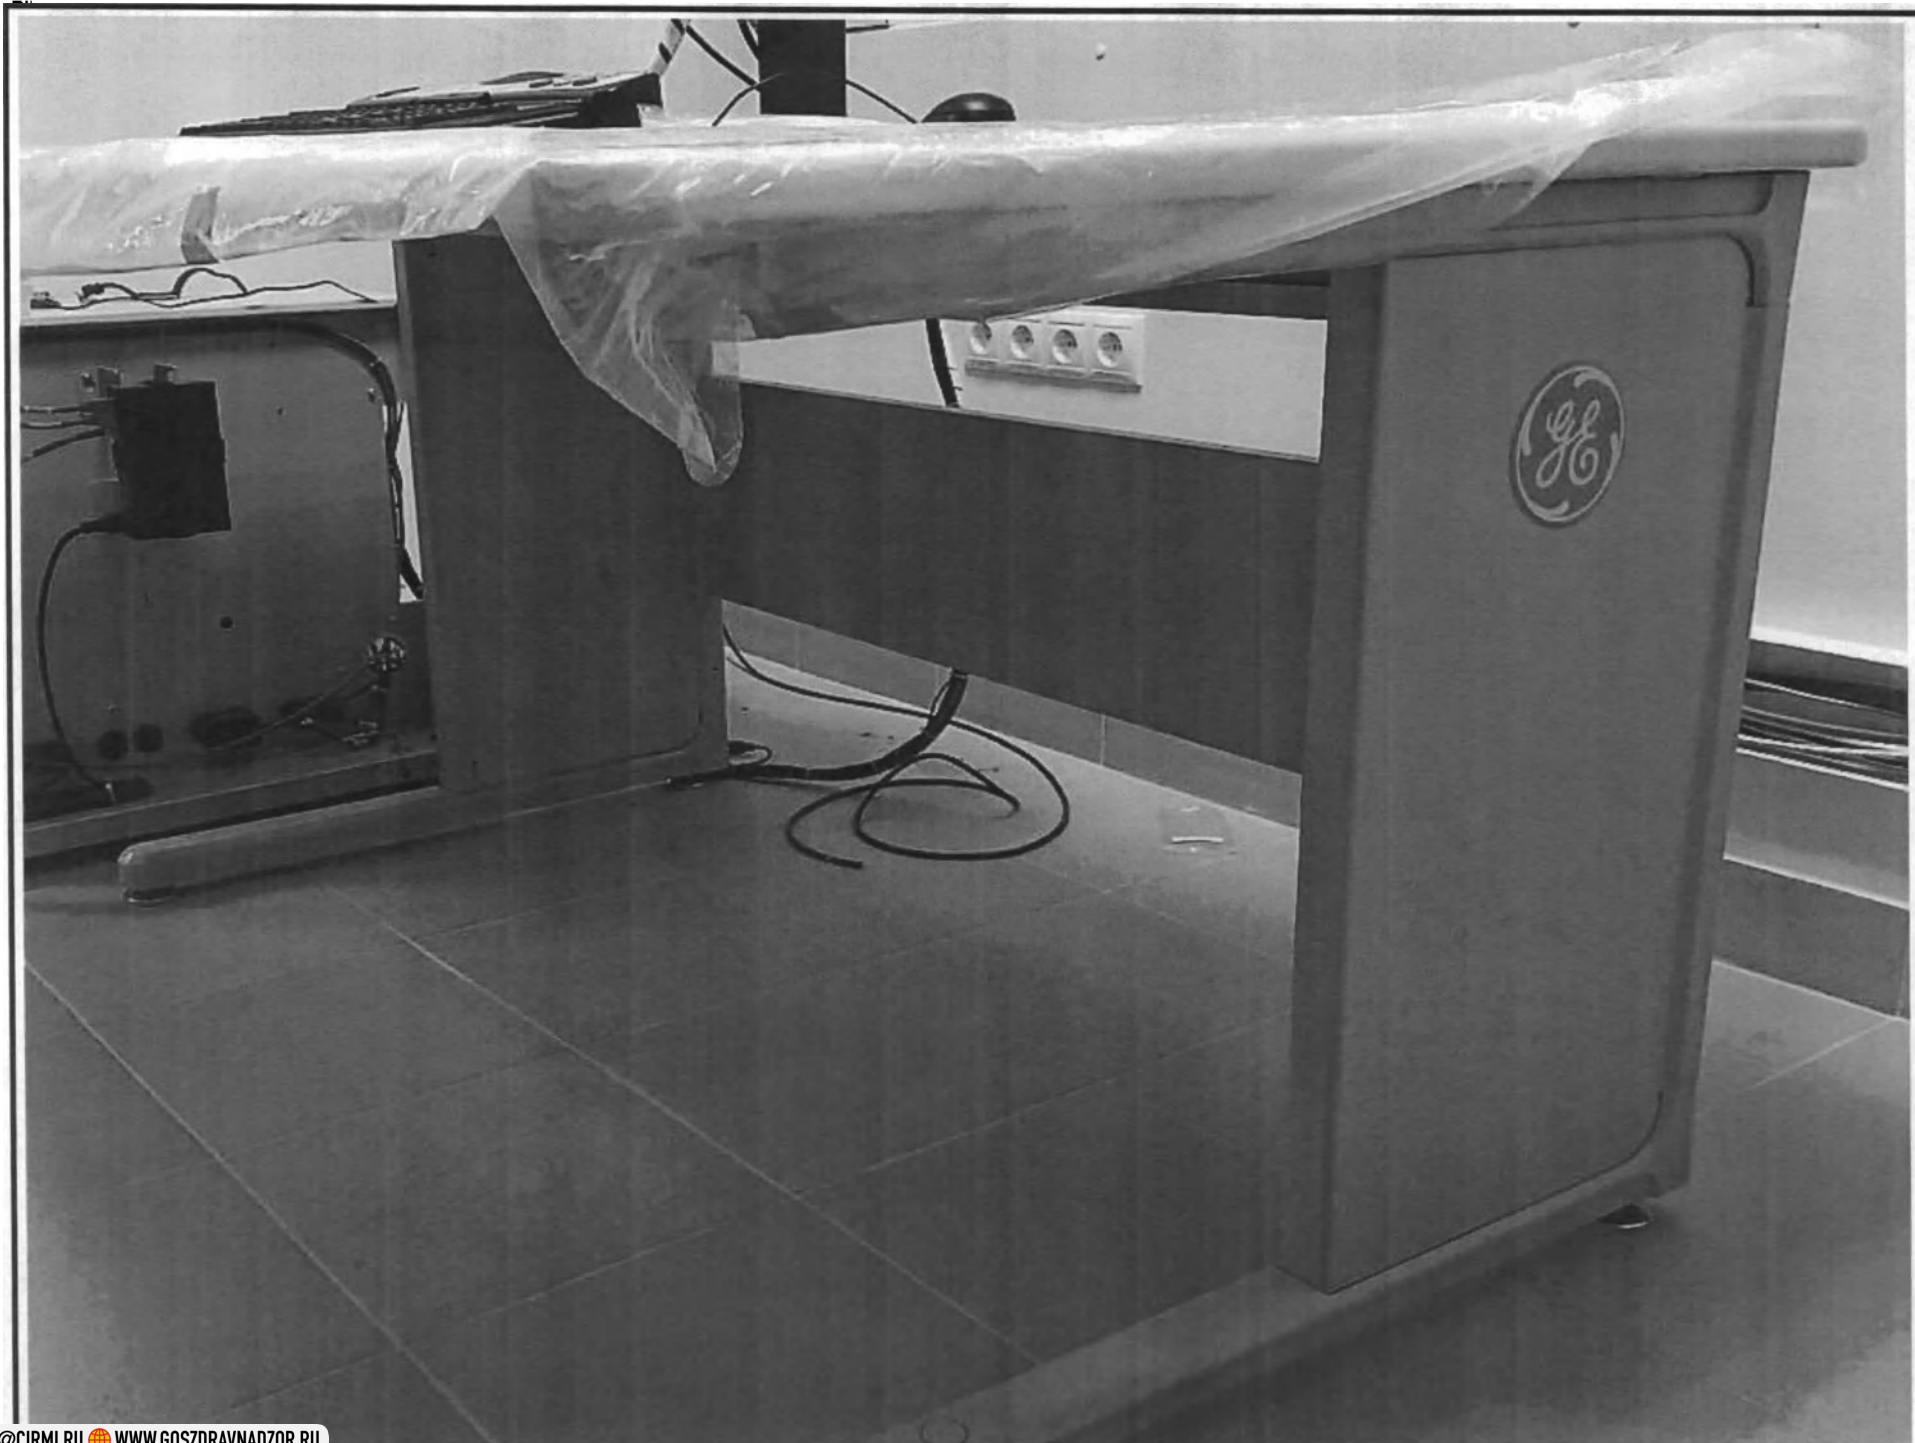

4. Стол оператора (не более 5 шт.).



5. Клавиатура специальная (не более 5 шт.).

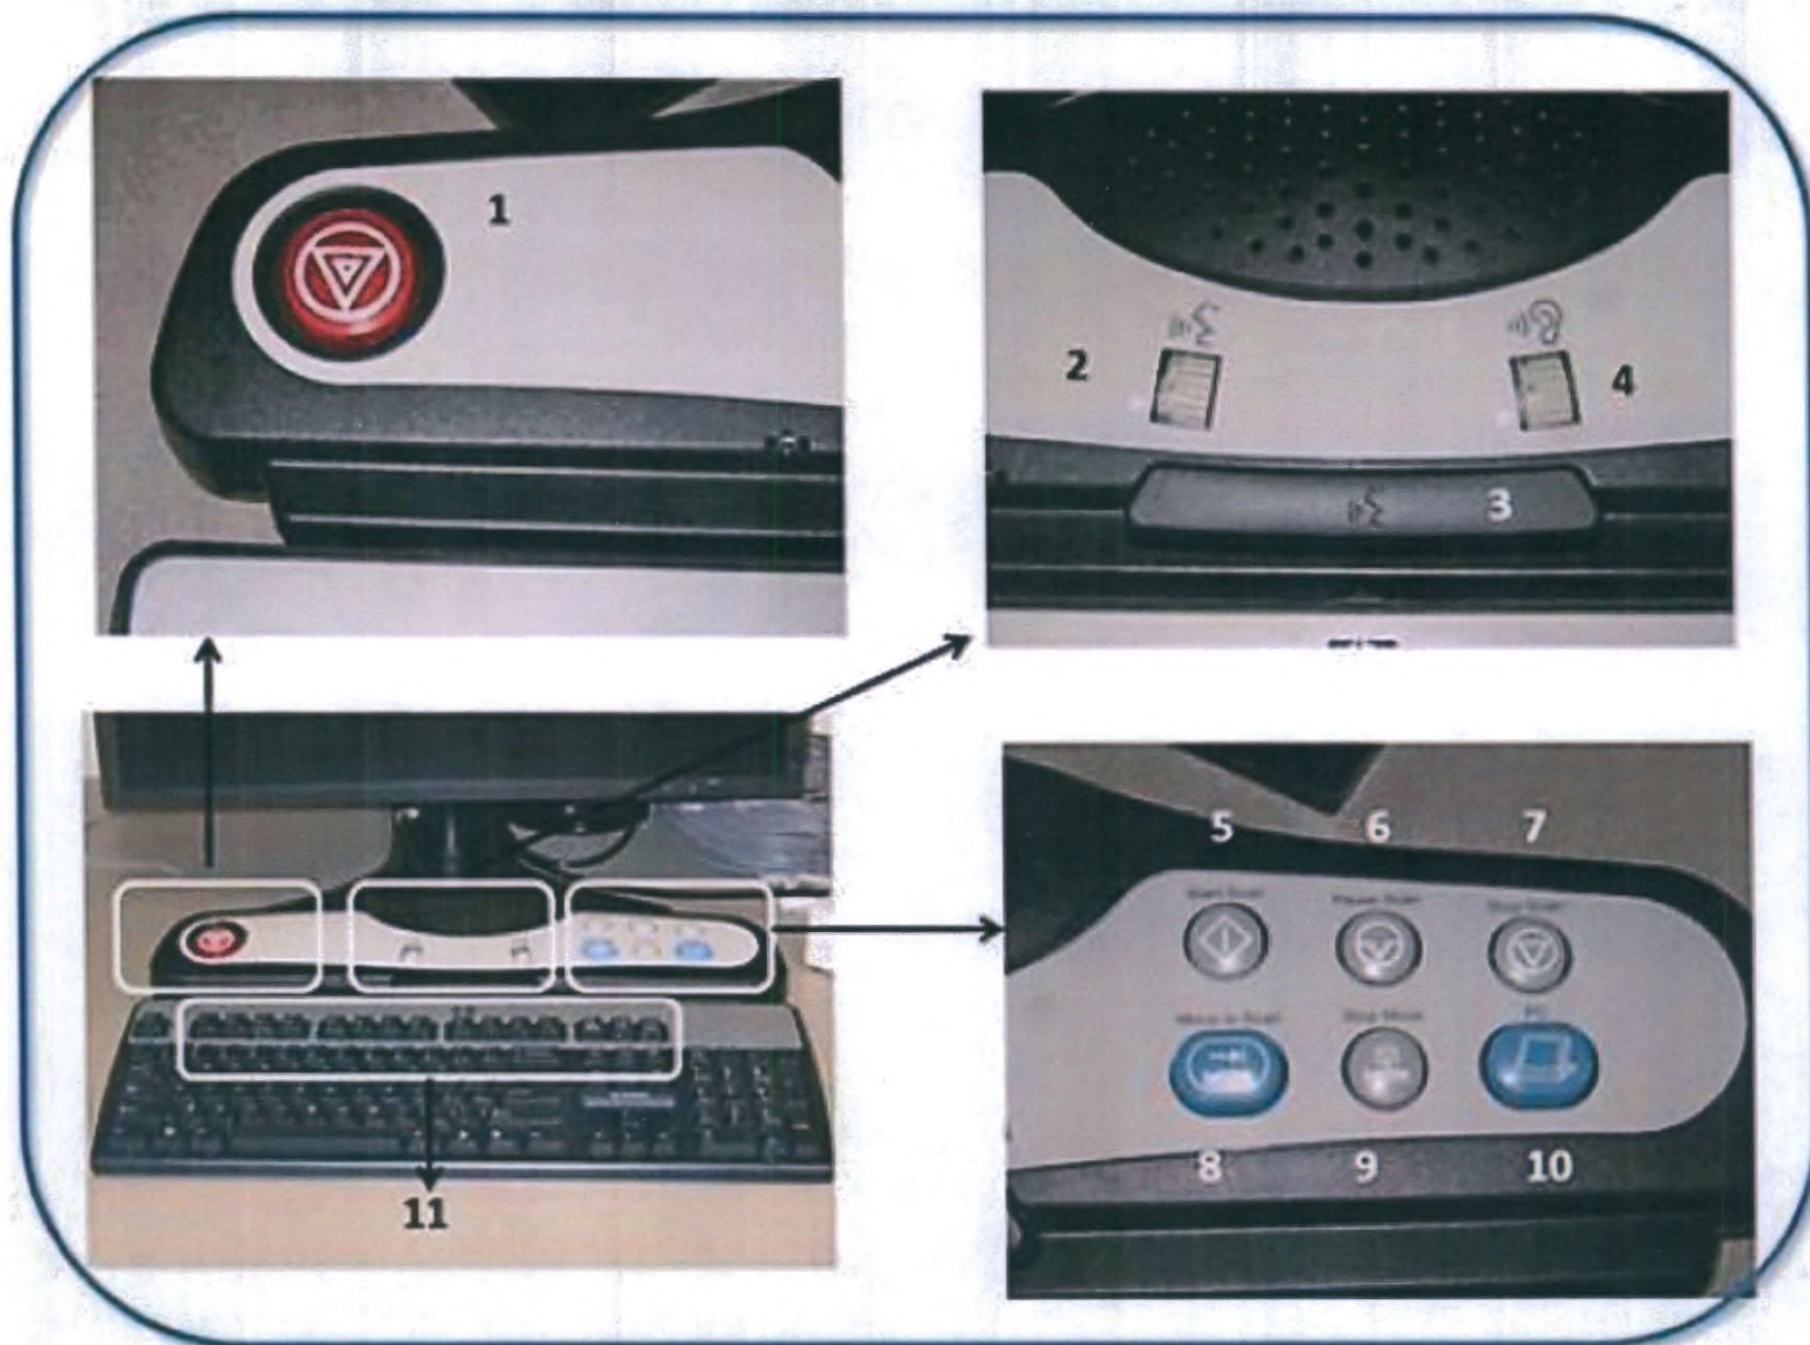


5. Клавиатура специальная (не более 5 шт.).





6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).

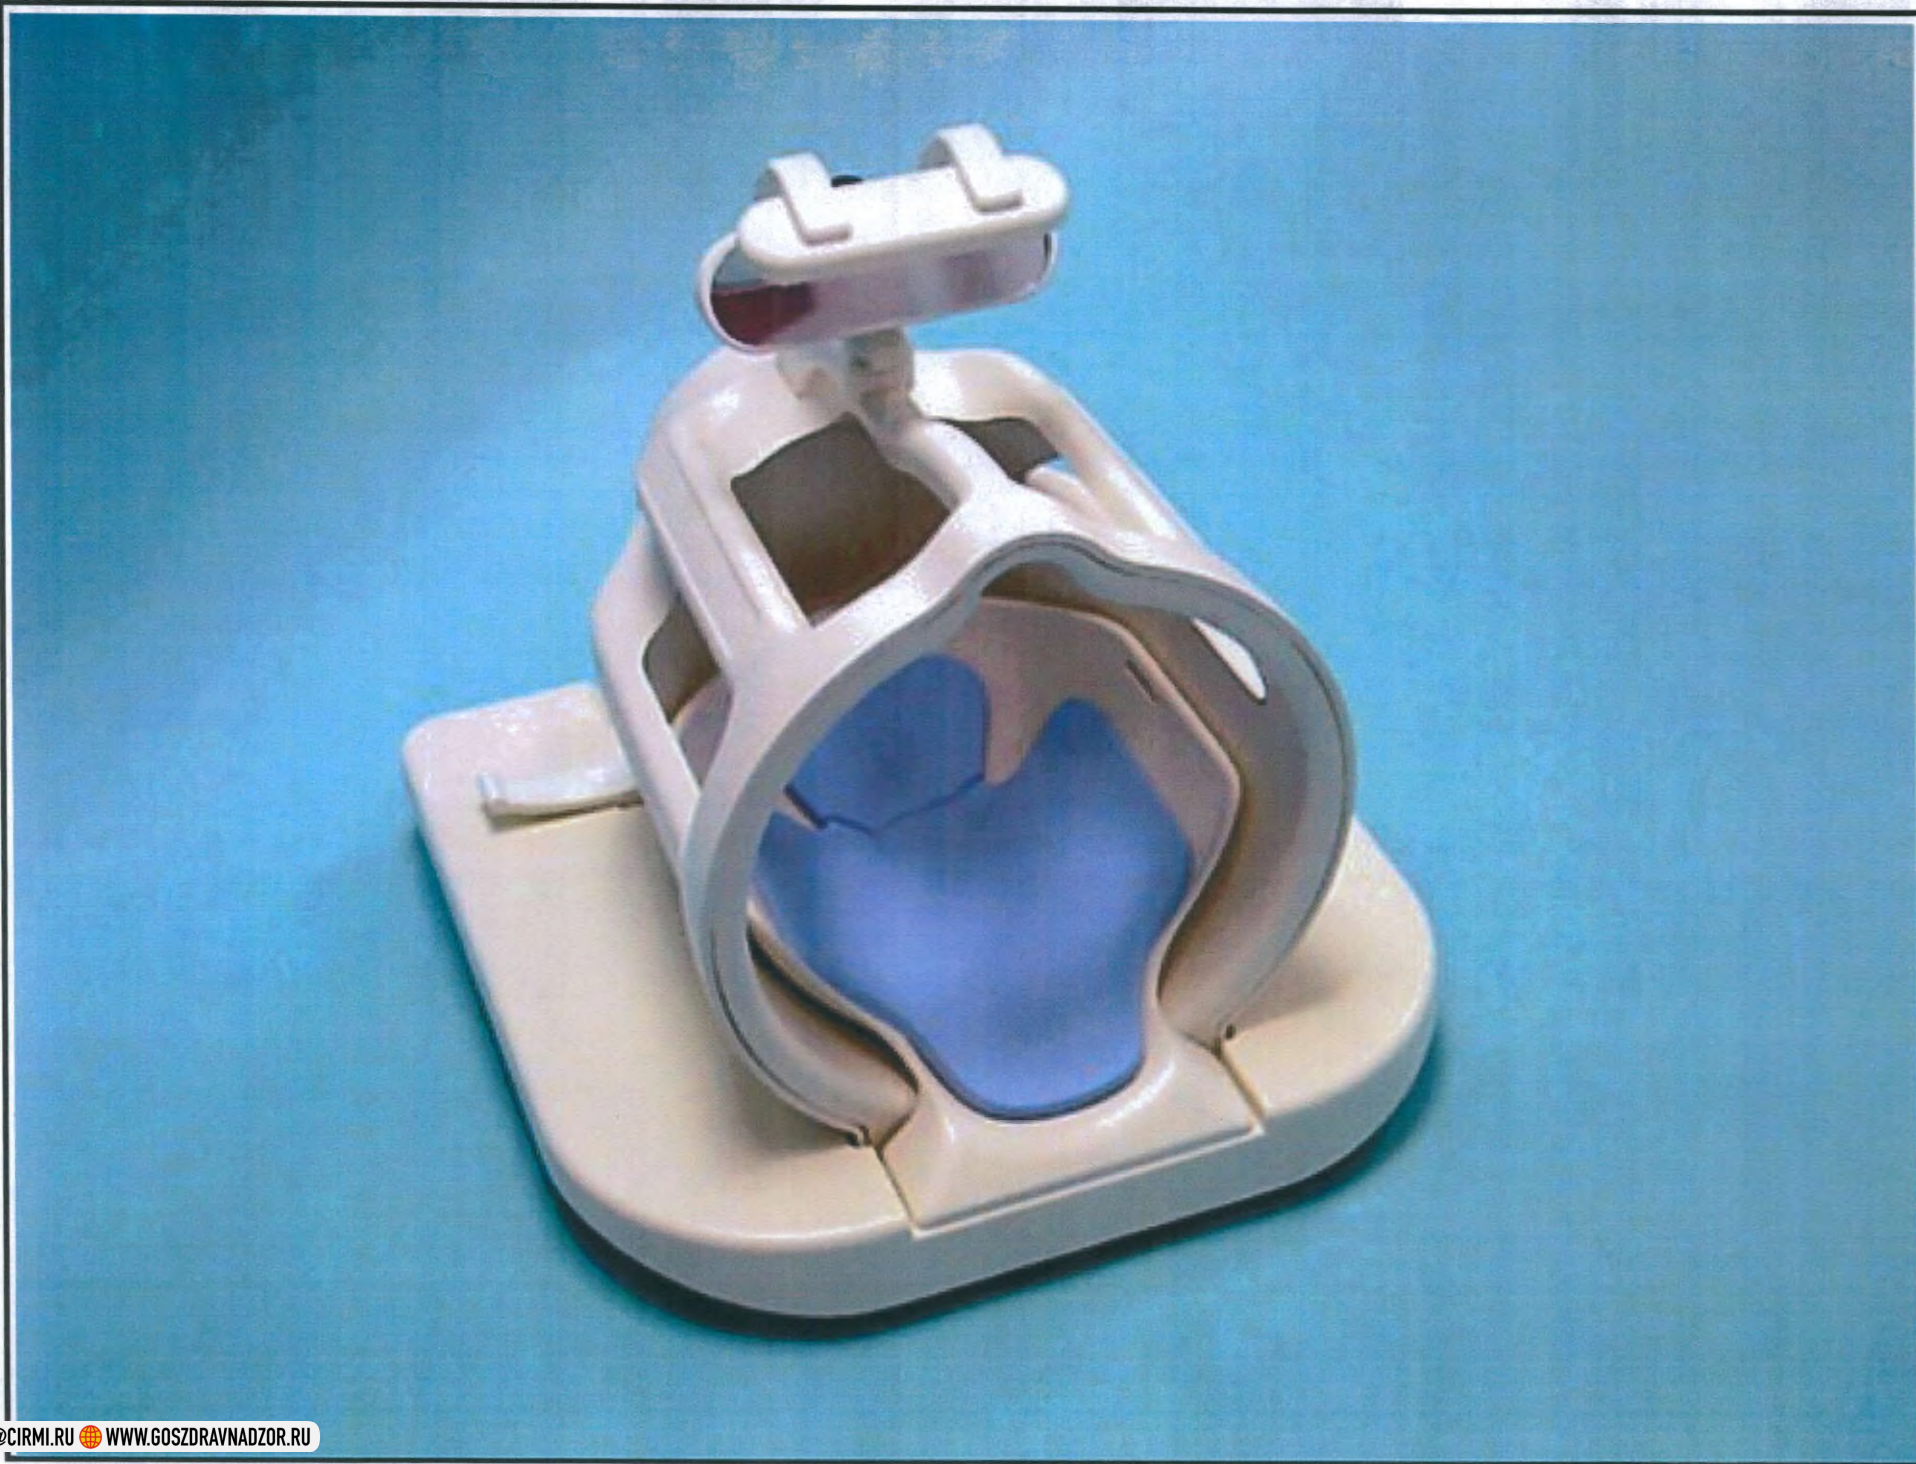


6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).



8. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).



7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).

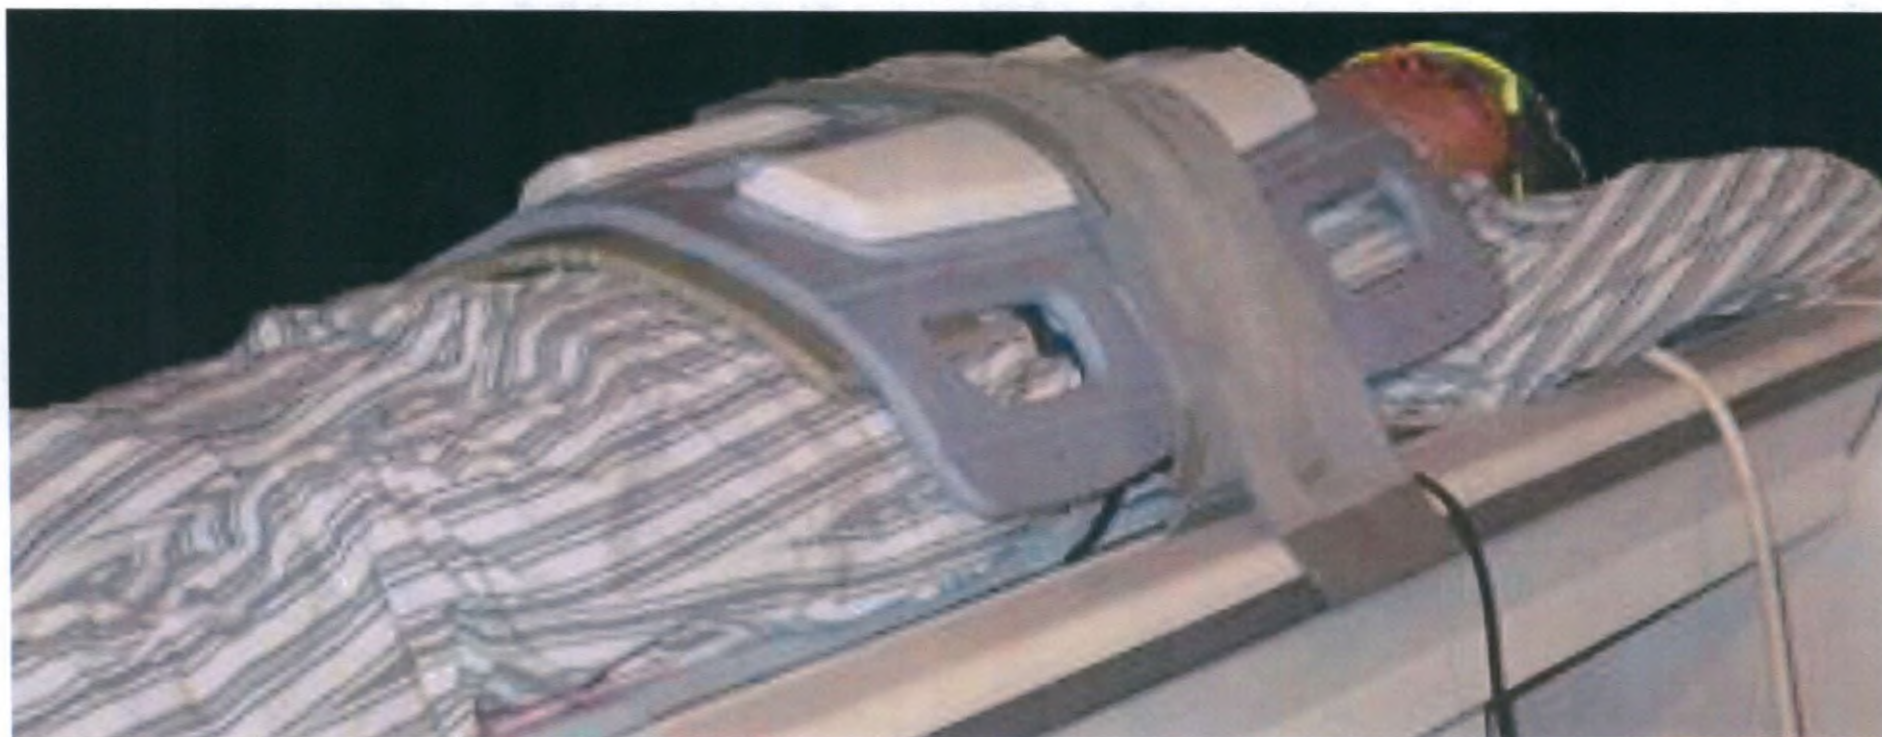

7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).



7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).



7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).




7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).



7. Катушки для исследования тела (не более 10 шт.).



8. Катушки для исследования нижних конечностей (не более 10 шт.).

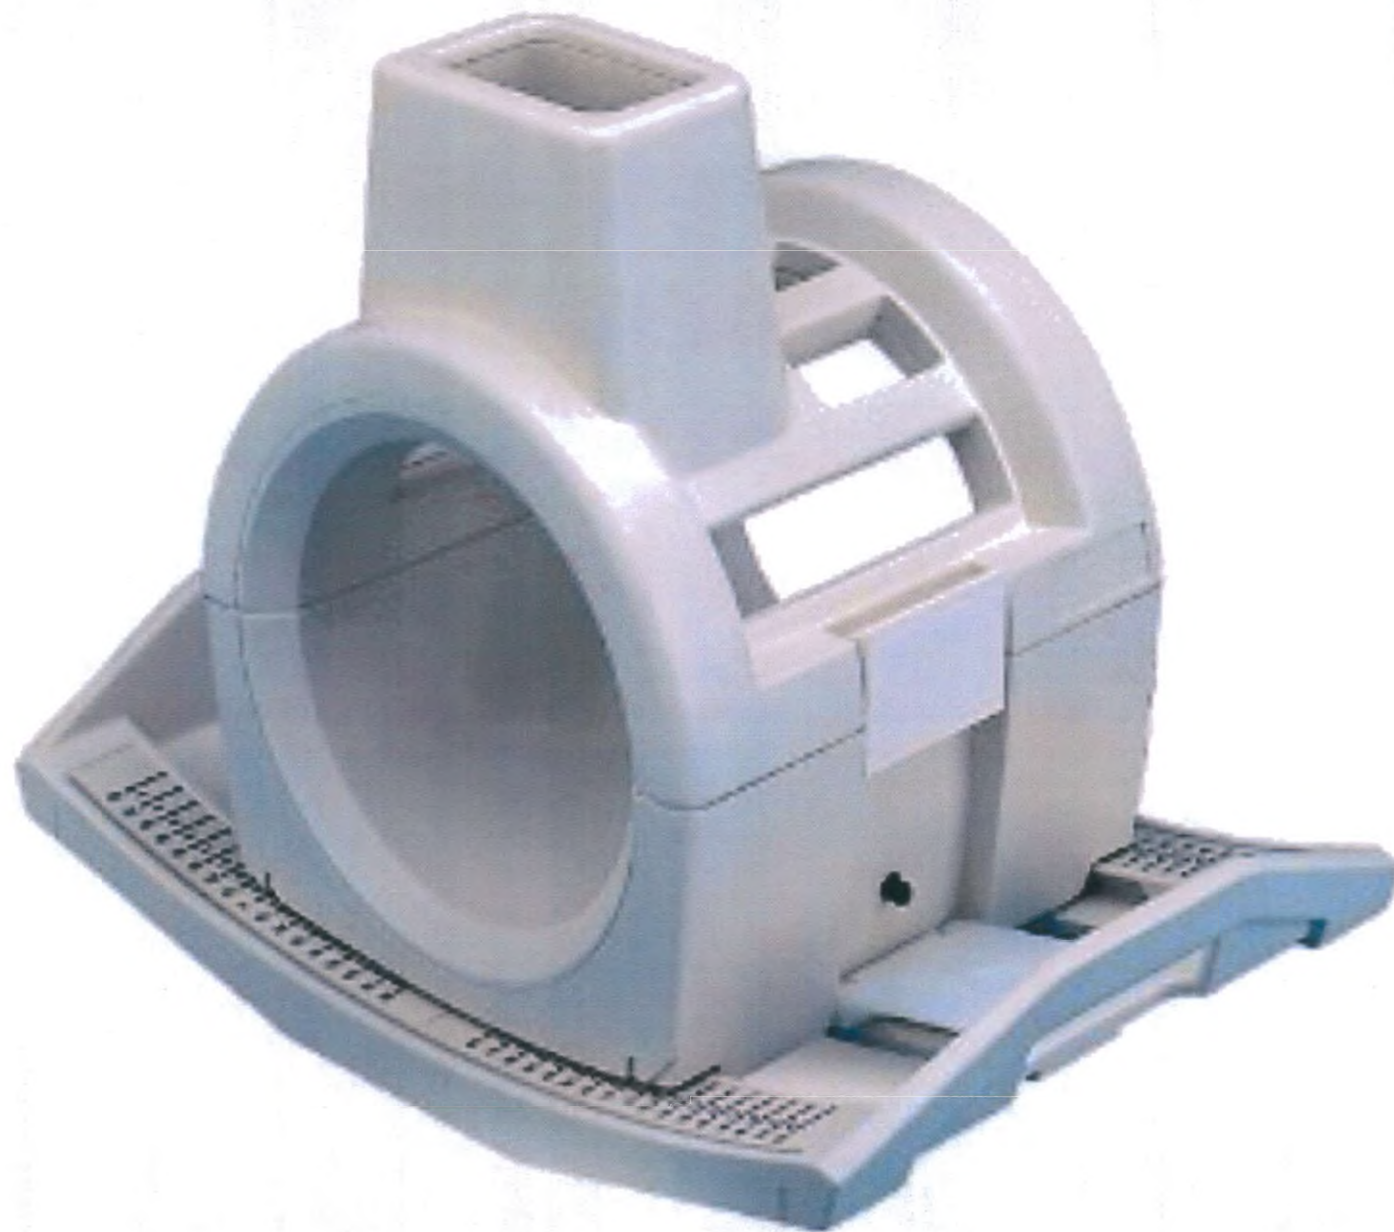



9. Катушки для исследования плечевого сустава (не более 10 шт.).




9. Катушки для исследования плечевого сустава (не более 10 шт.).





10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).





10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

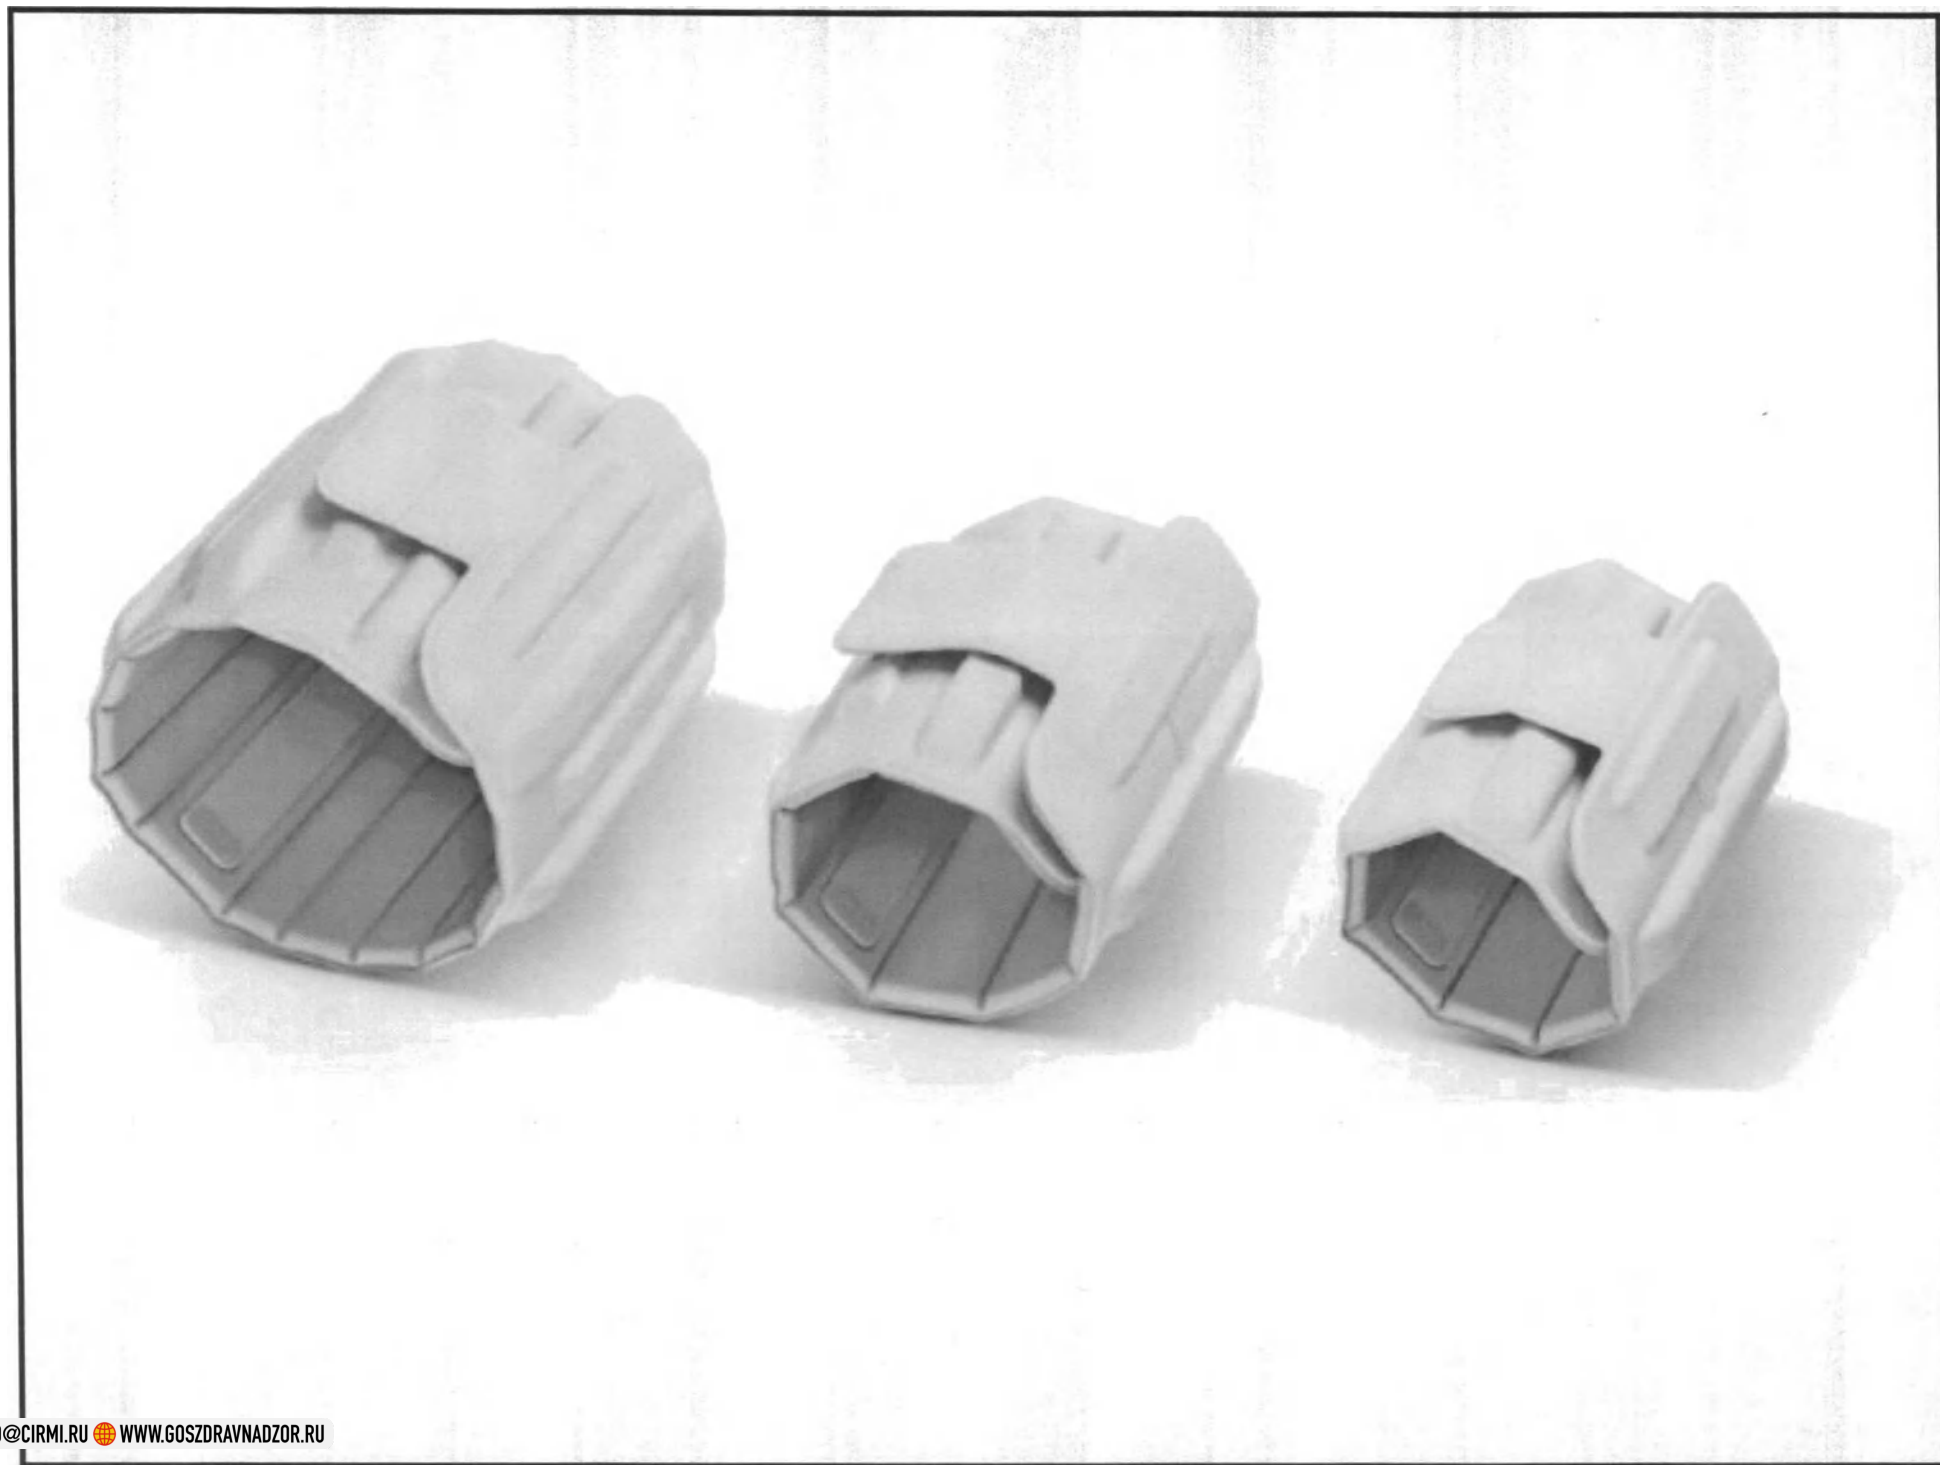


10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

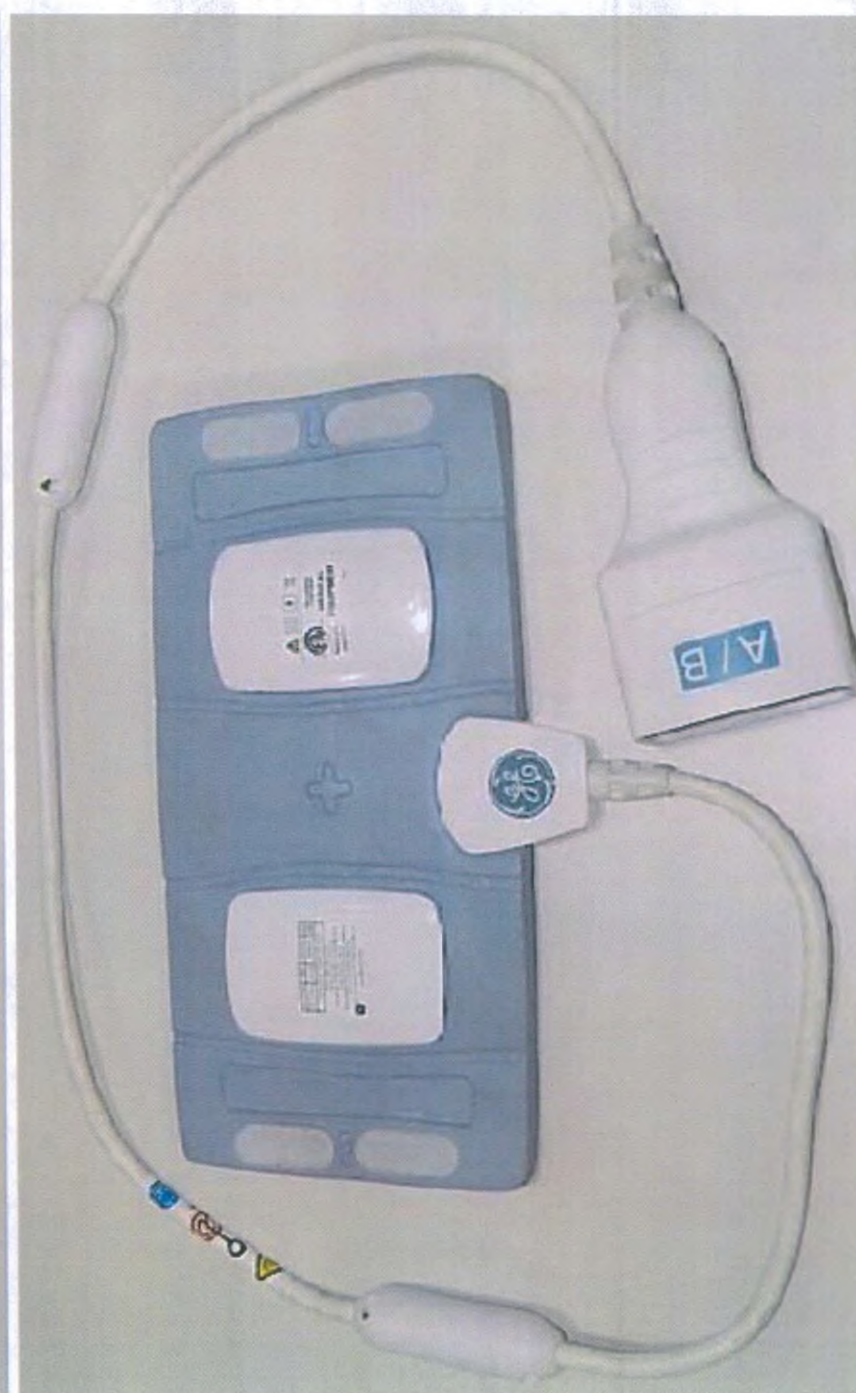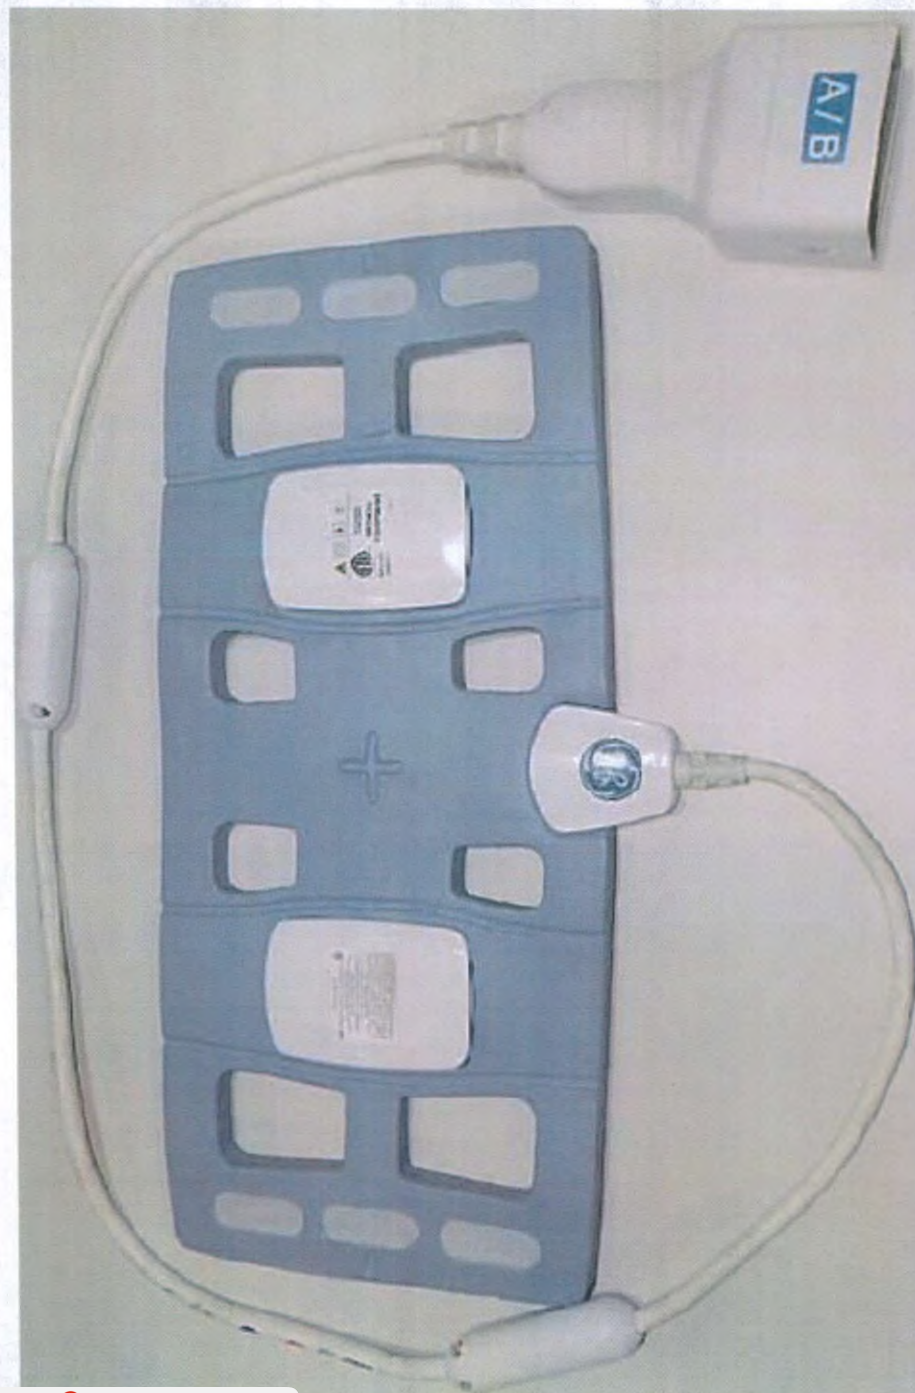

10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

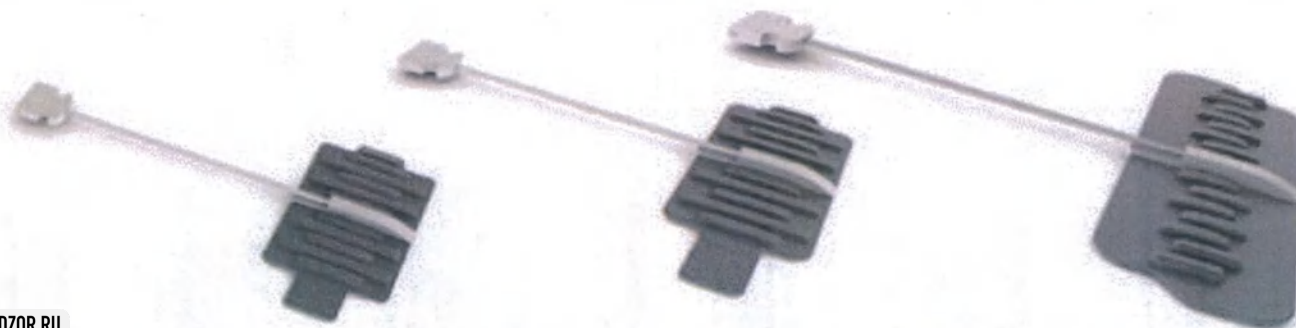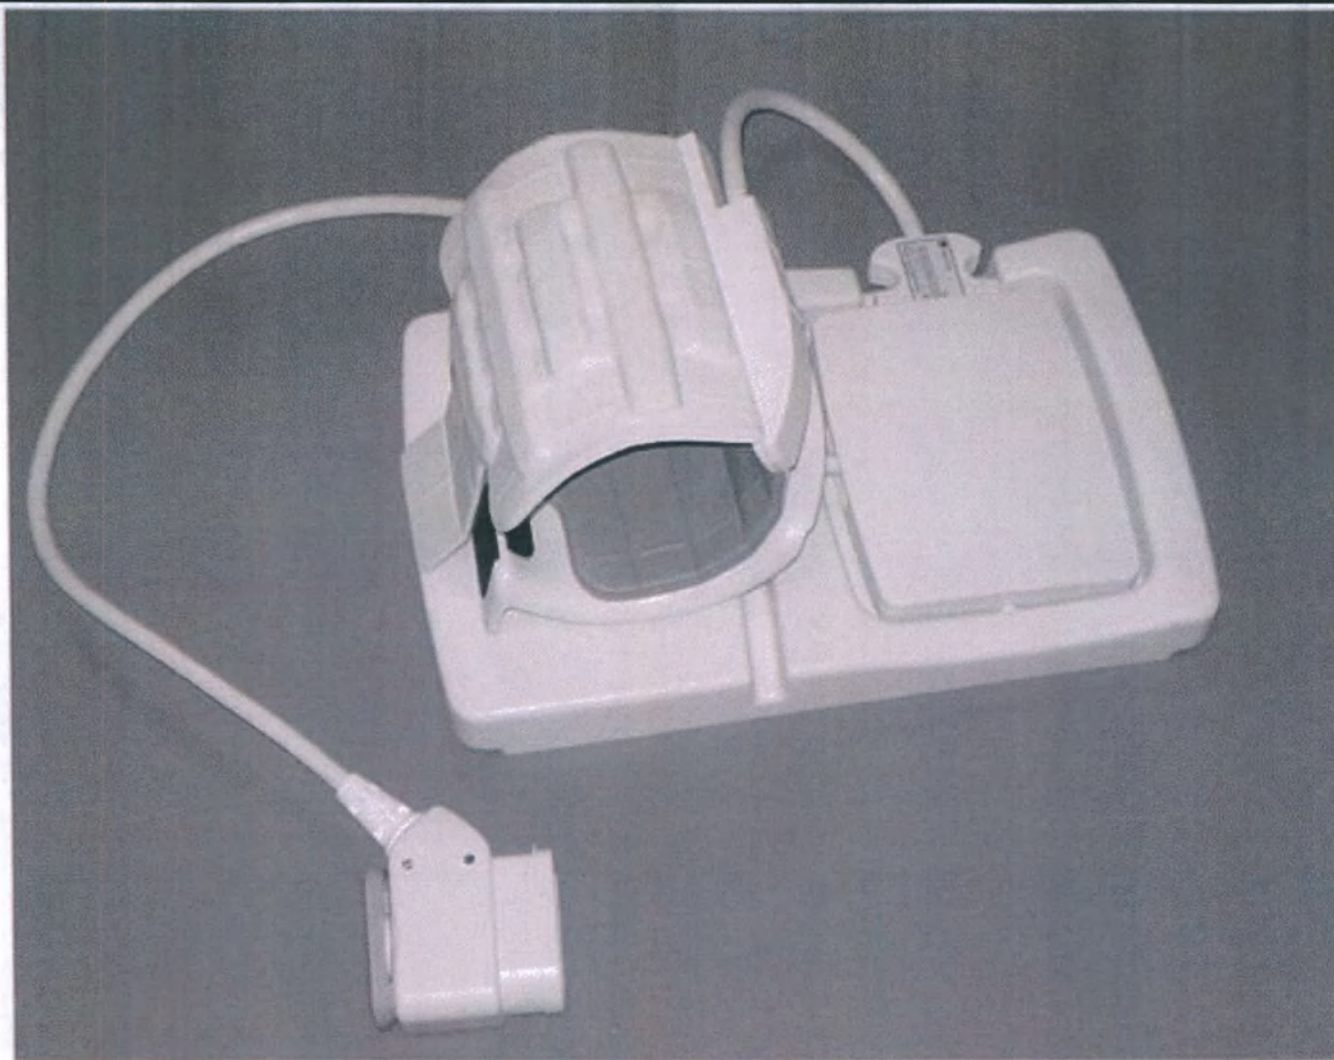

11. Катушки круглые общего назначения (не более 5 шт.).

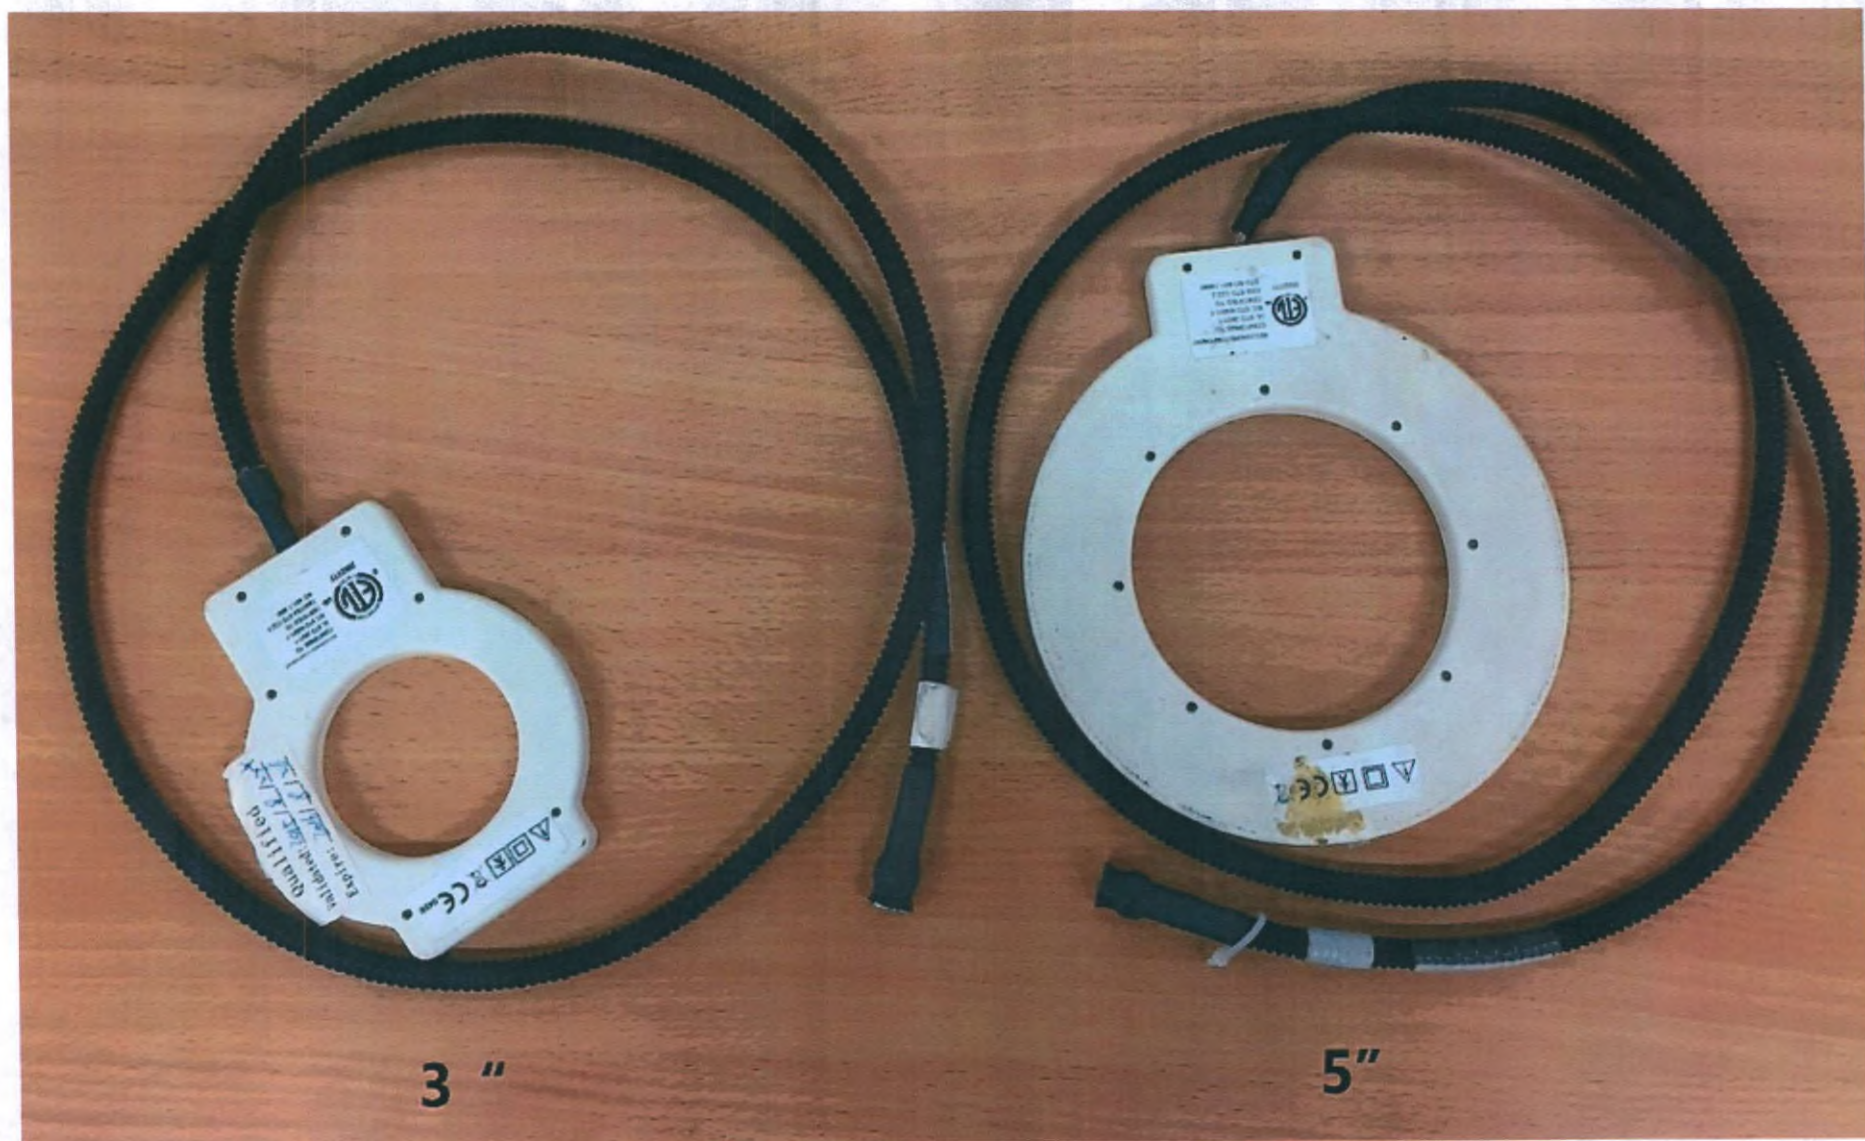

12. Катушки для исследования молочных желез (не более 5 шт.).




12. Катушки для исследования молочных желез (не более 5 шт.).






14. Катушка для исследования головы, шеи и позвоночника.




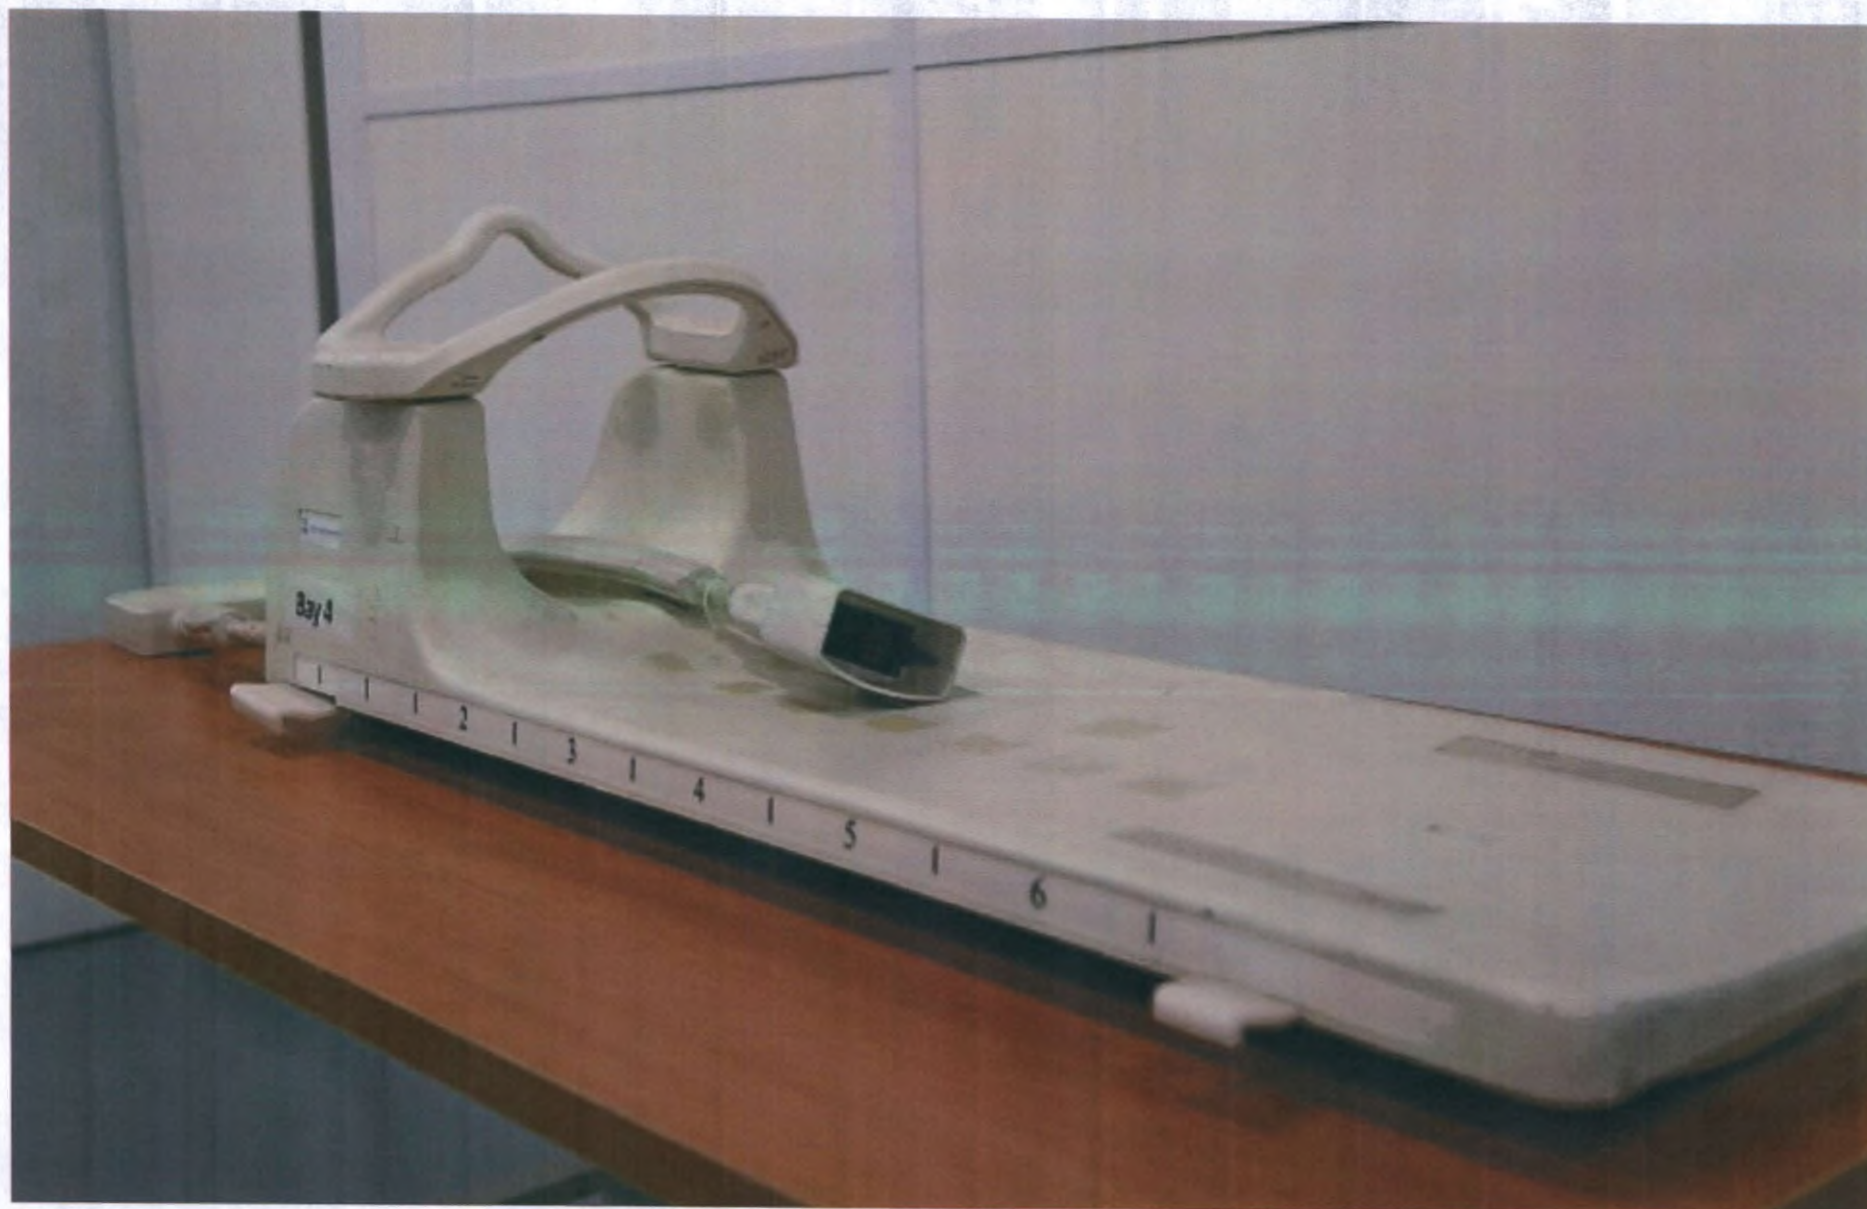


16. Катушка для исследования запястья.



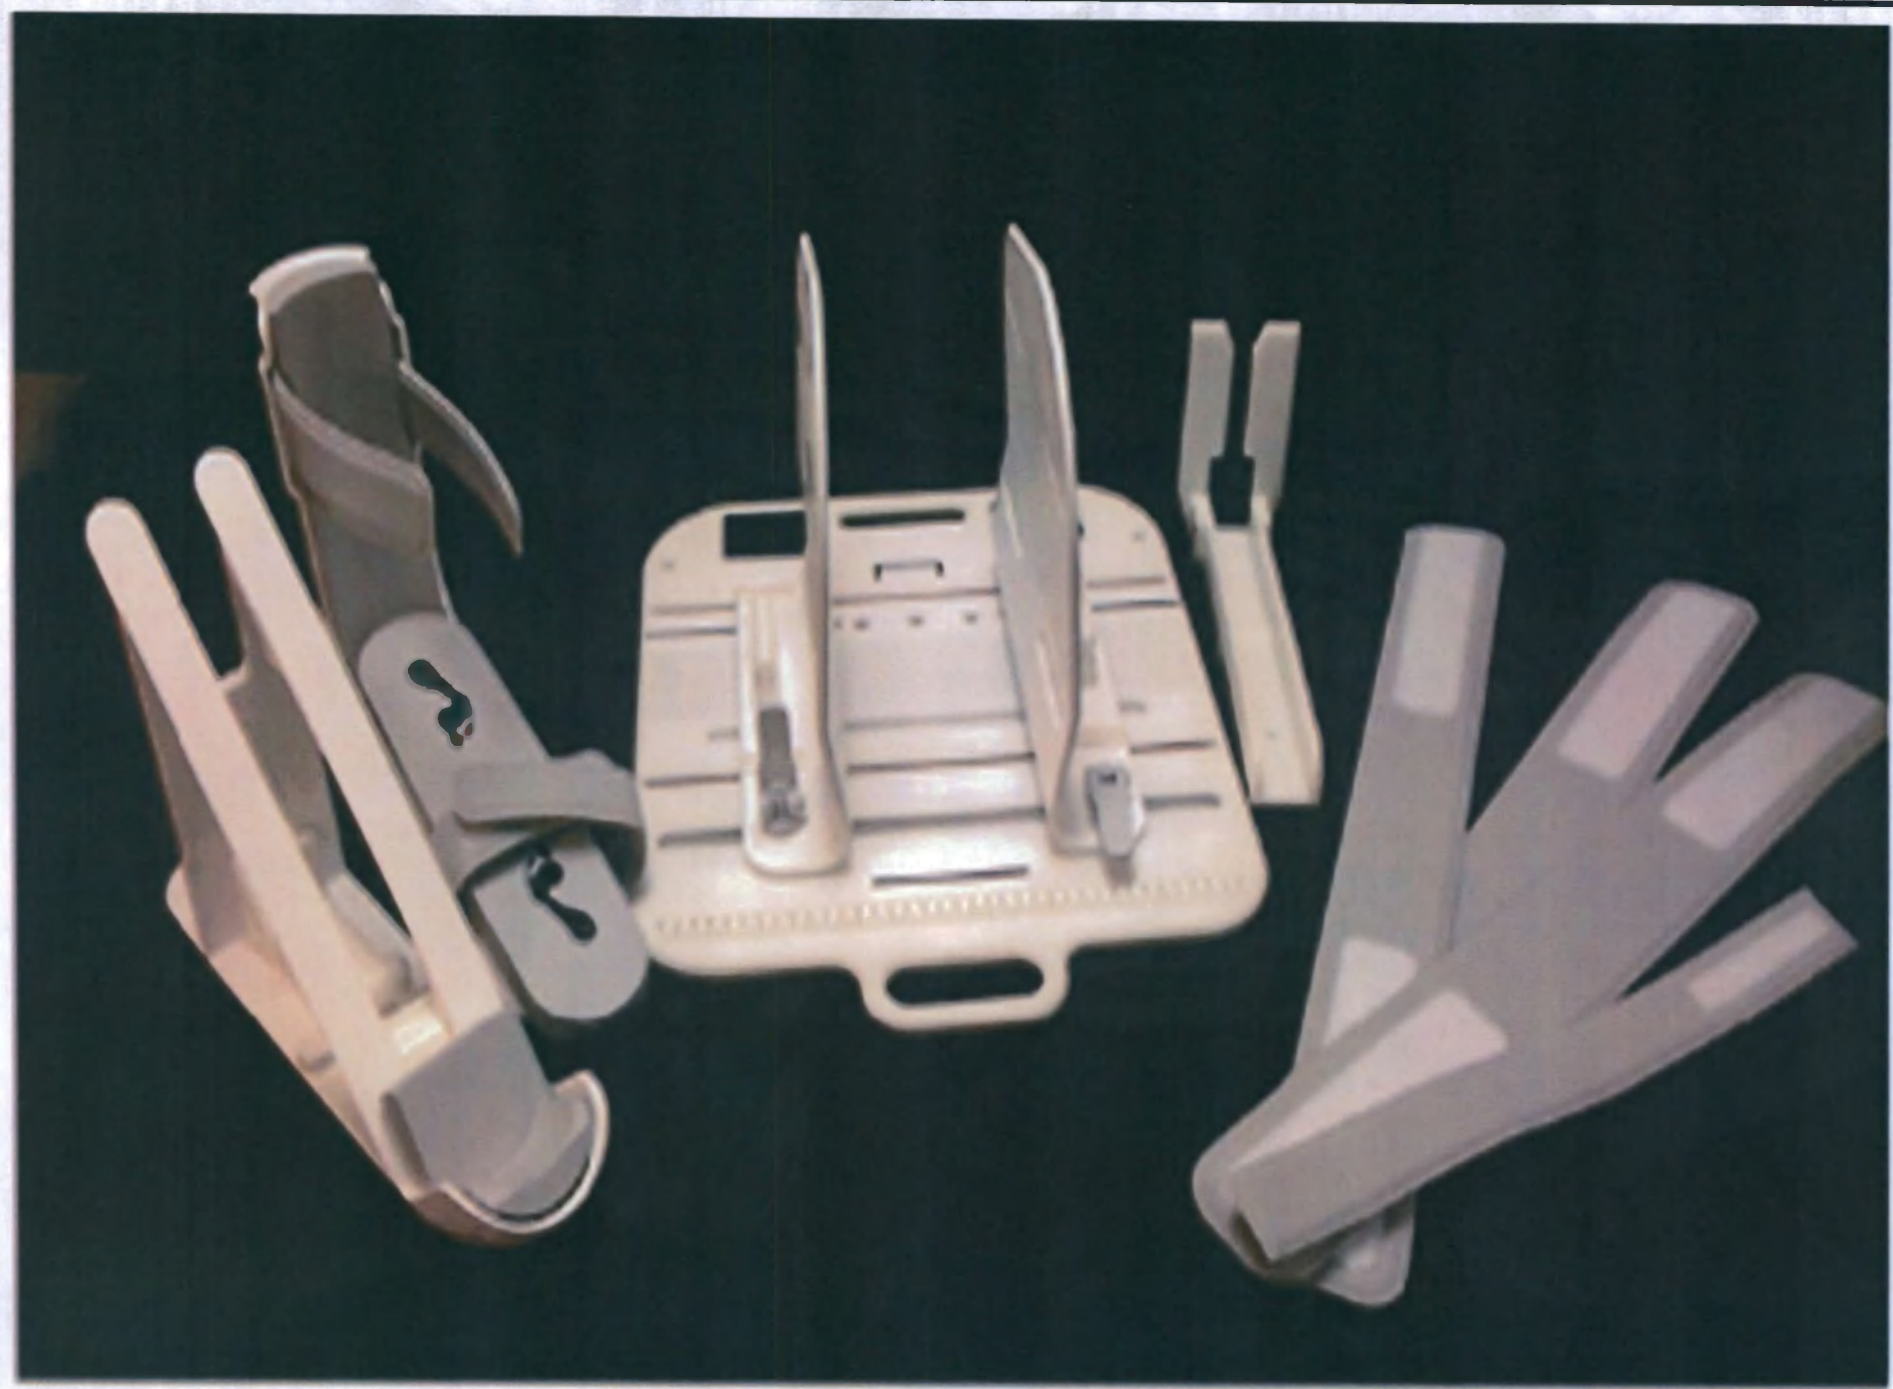

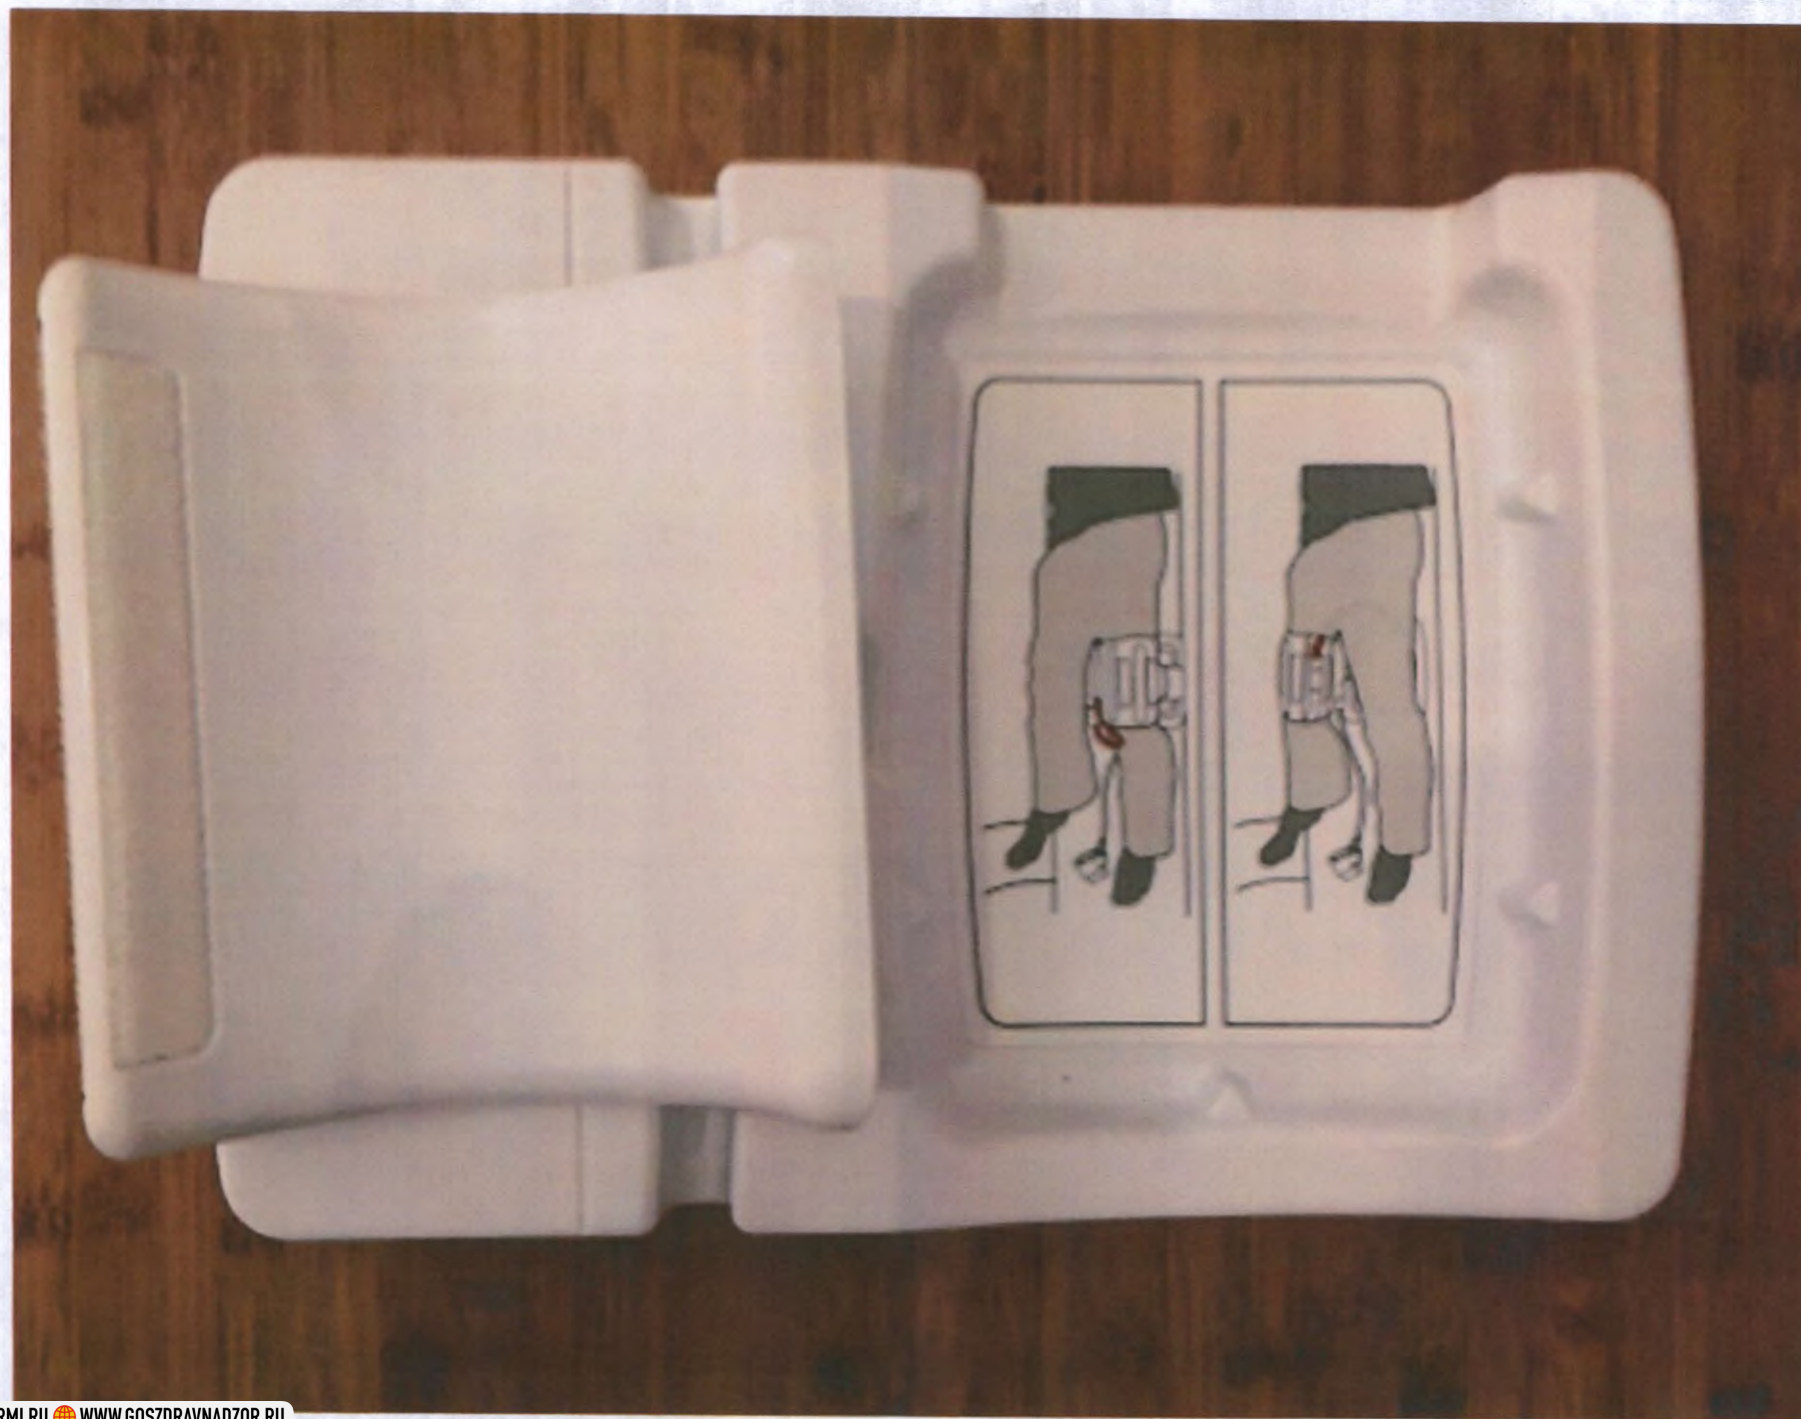

17. Позиционер для гибких катушек.

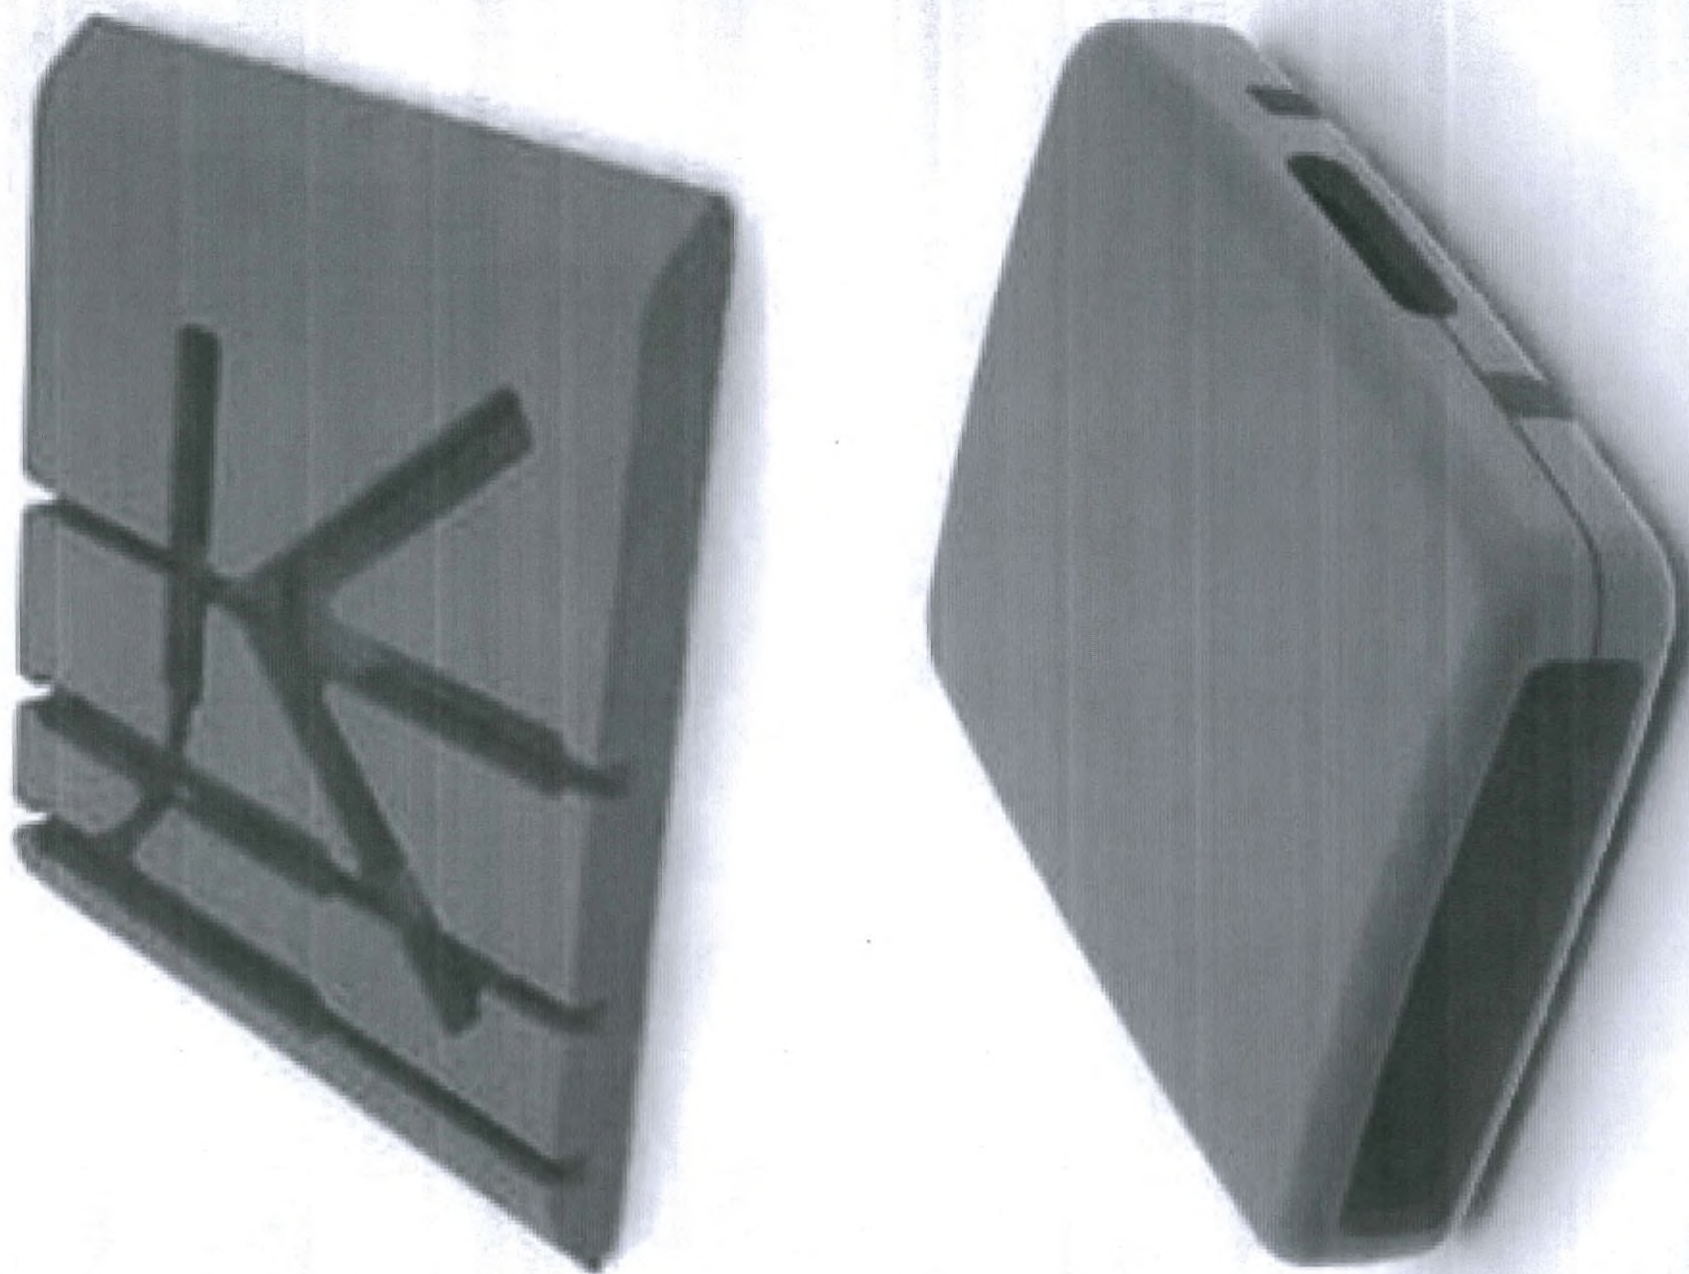

18. Устройство для позиционирования челюстей пациента (не более 15 шт.).





19. Валики для позиционирования (не более 15 шт.).







19. Валики для позиционирования (не более 15 шт.).



20. Программное обеспечение для установки операционной системы на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более



20. Программное обеспечение для установки операционной системы на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более





21. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более 150 шт.).







21. Программное обеспечение для программных приложений к системе МР томографа на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях²⁴ (не более 150 шт.).



22. Ключи электронные для лицензирования программных приложений на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более 150 шт.).




23. Фантомы (не более 15 шт.).







23. Фантомы (не более 15 шт.).

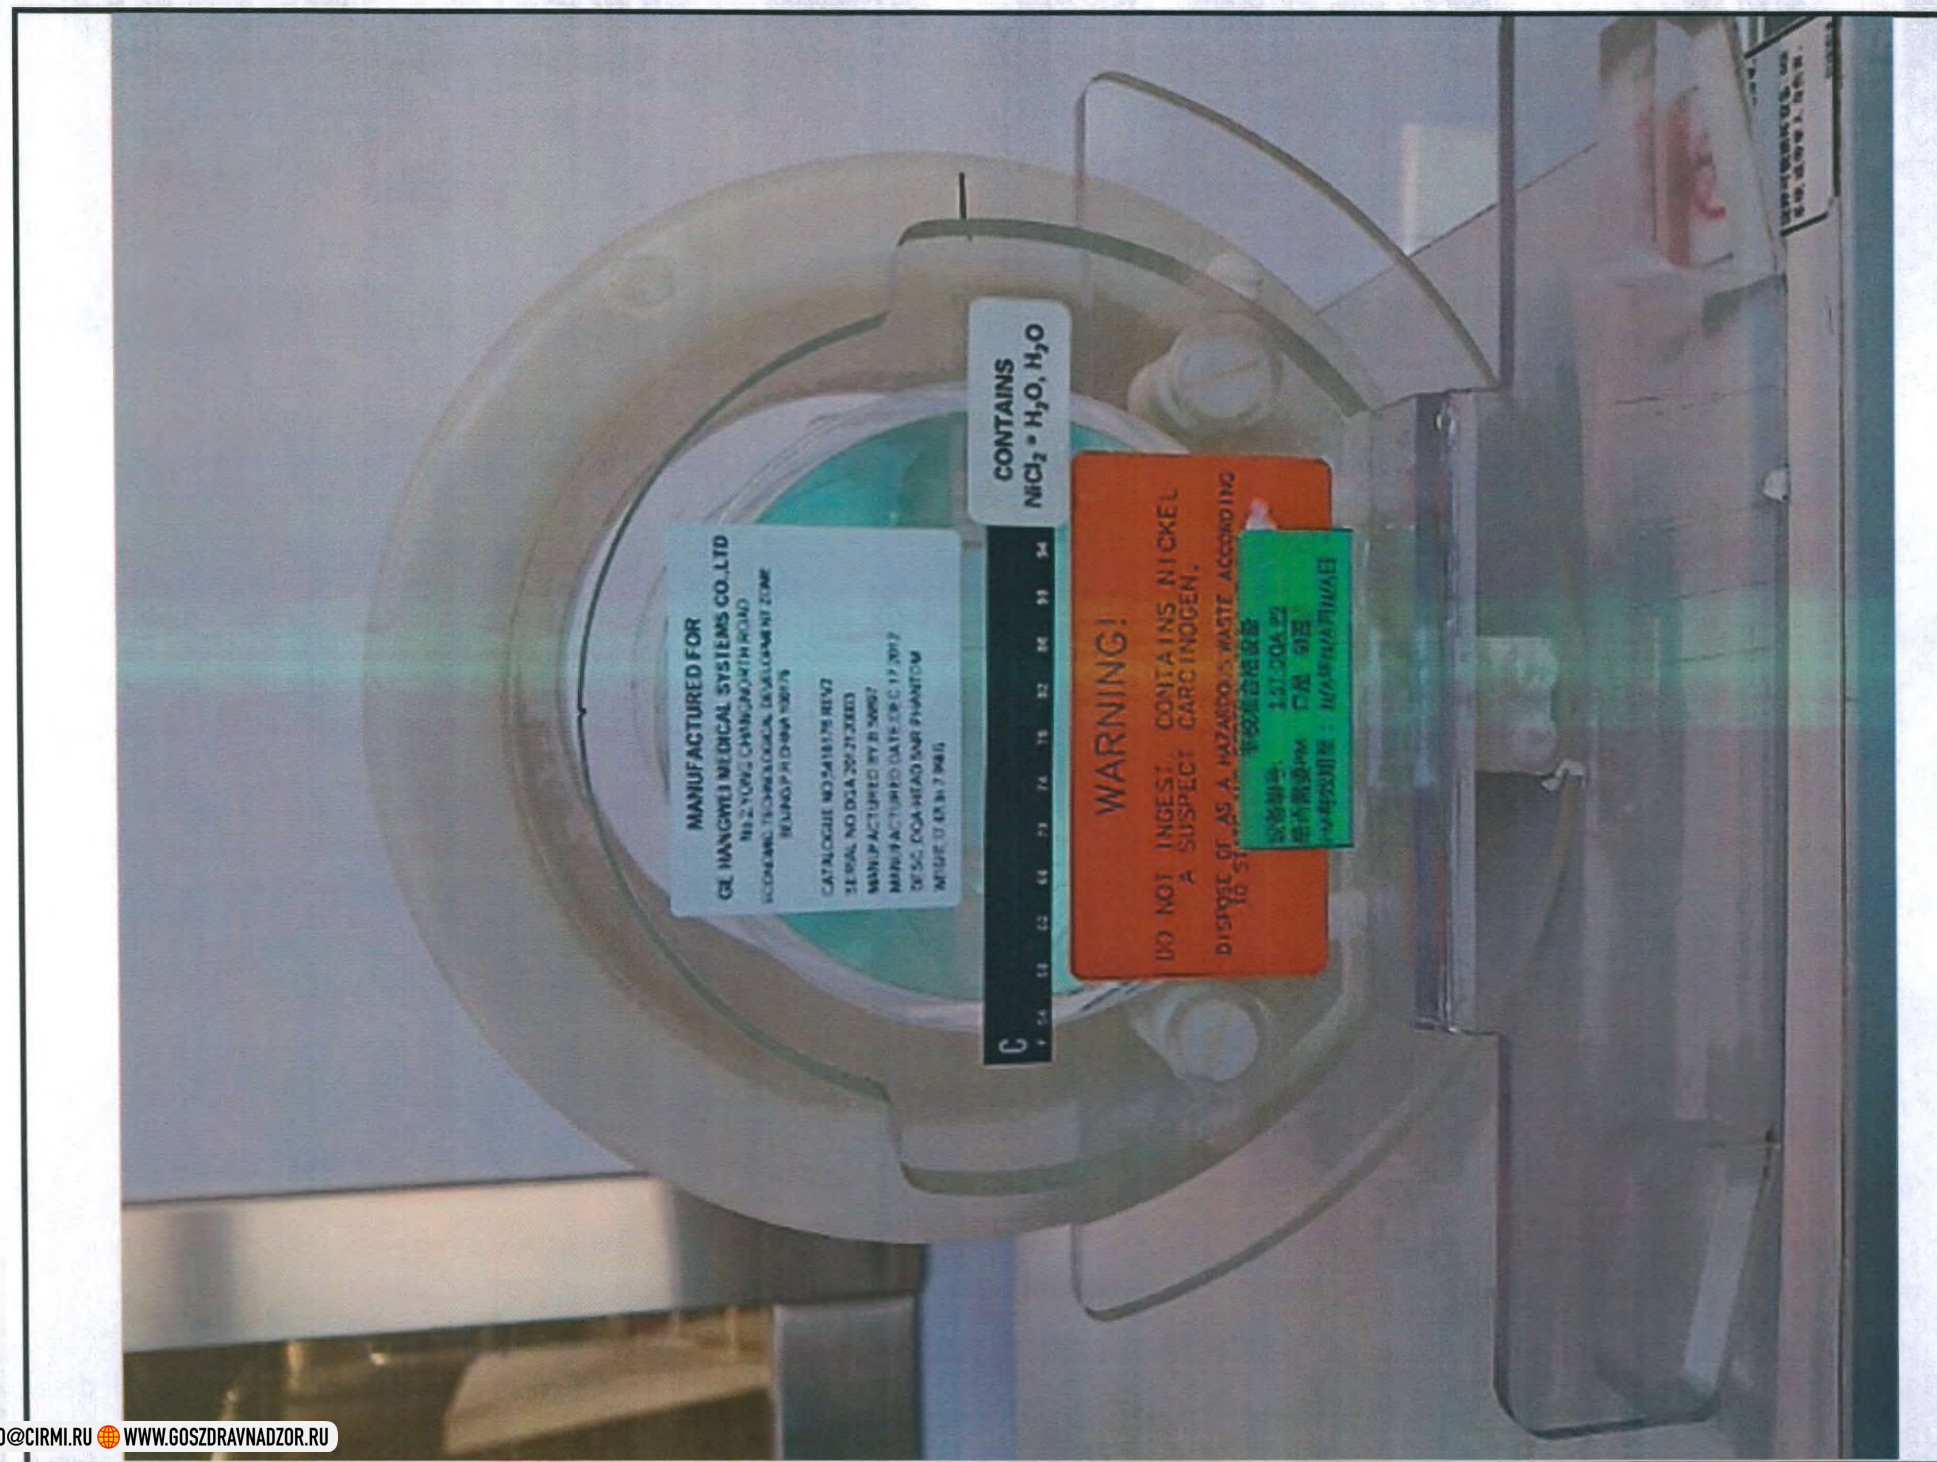



23. Фантомы (не более 15 шт.).



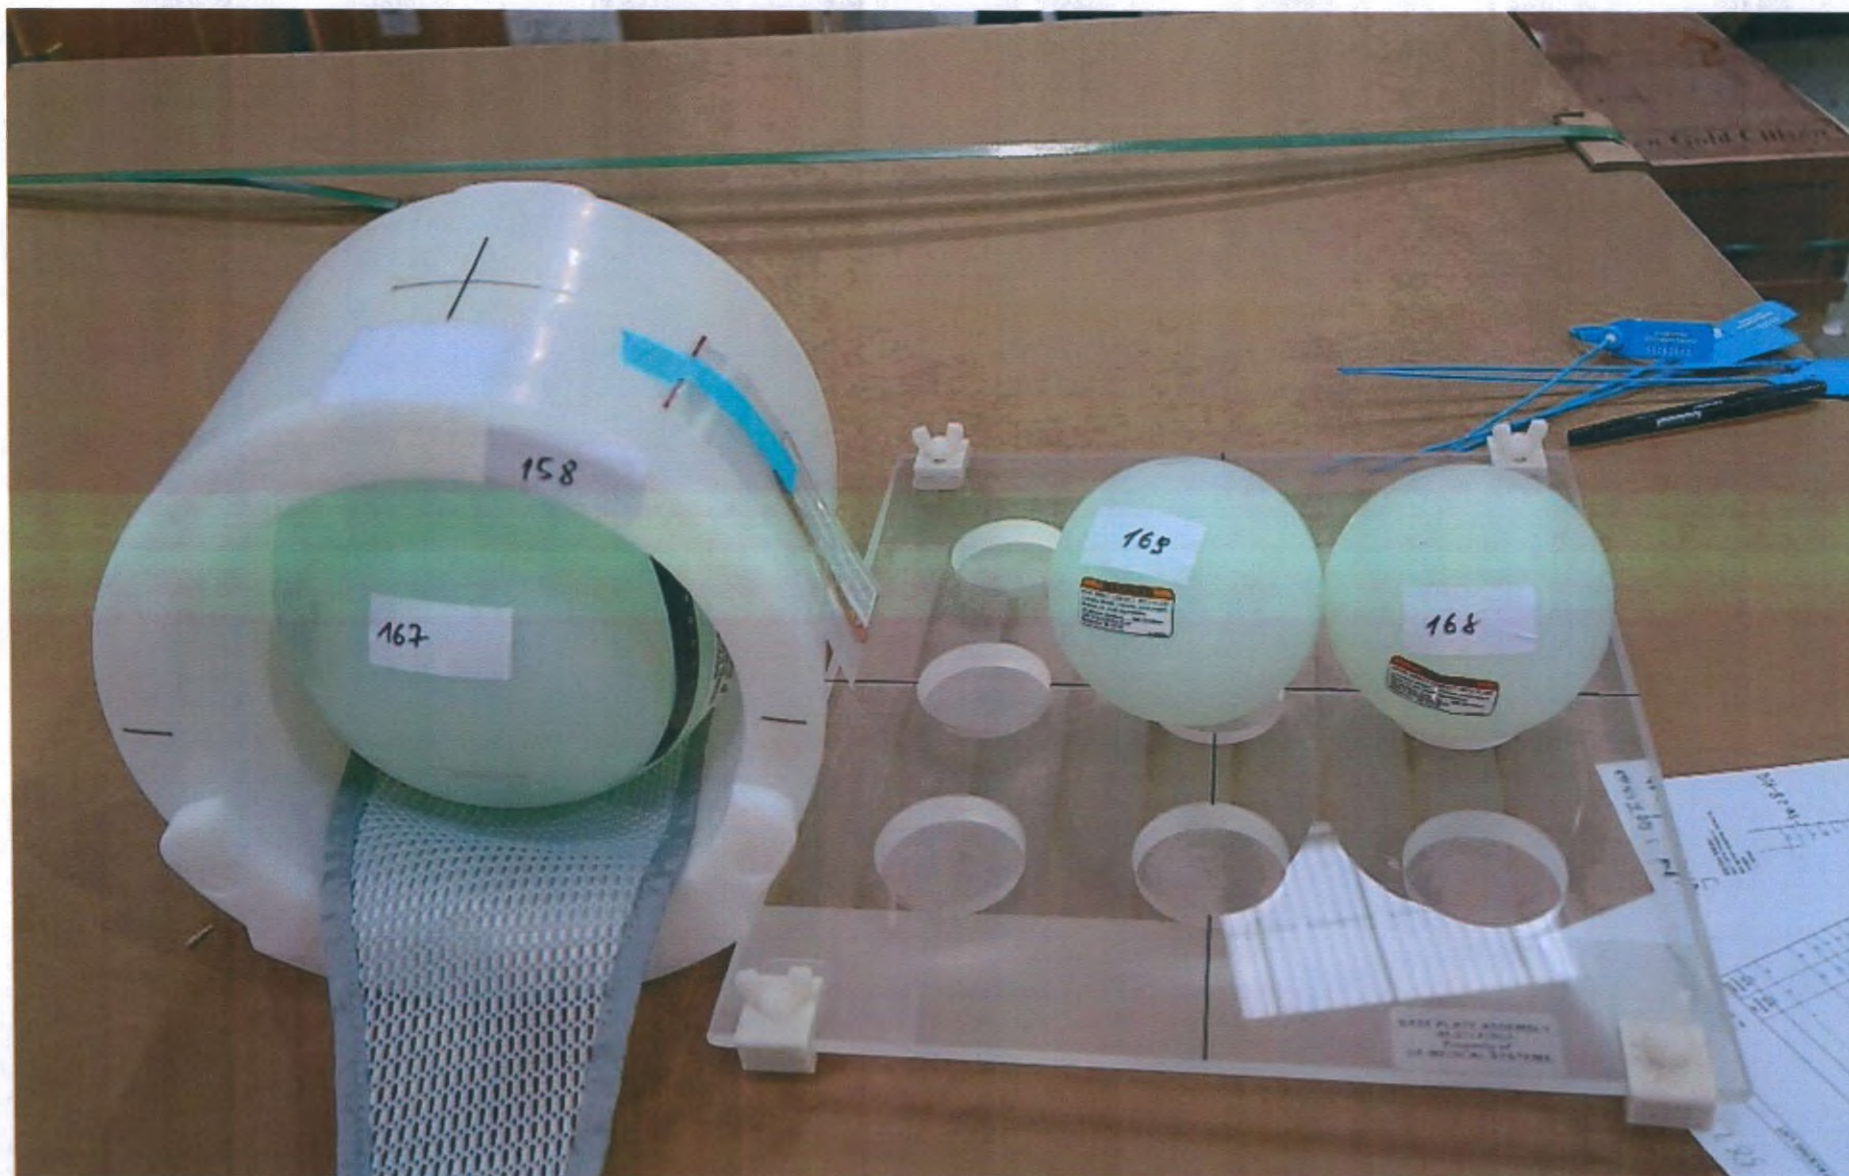


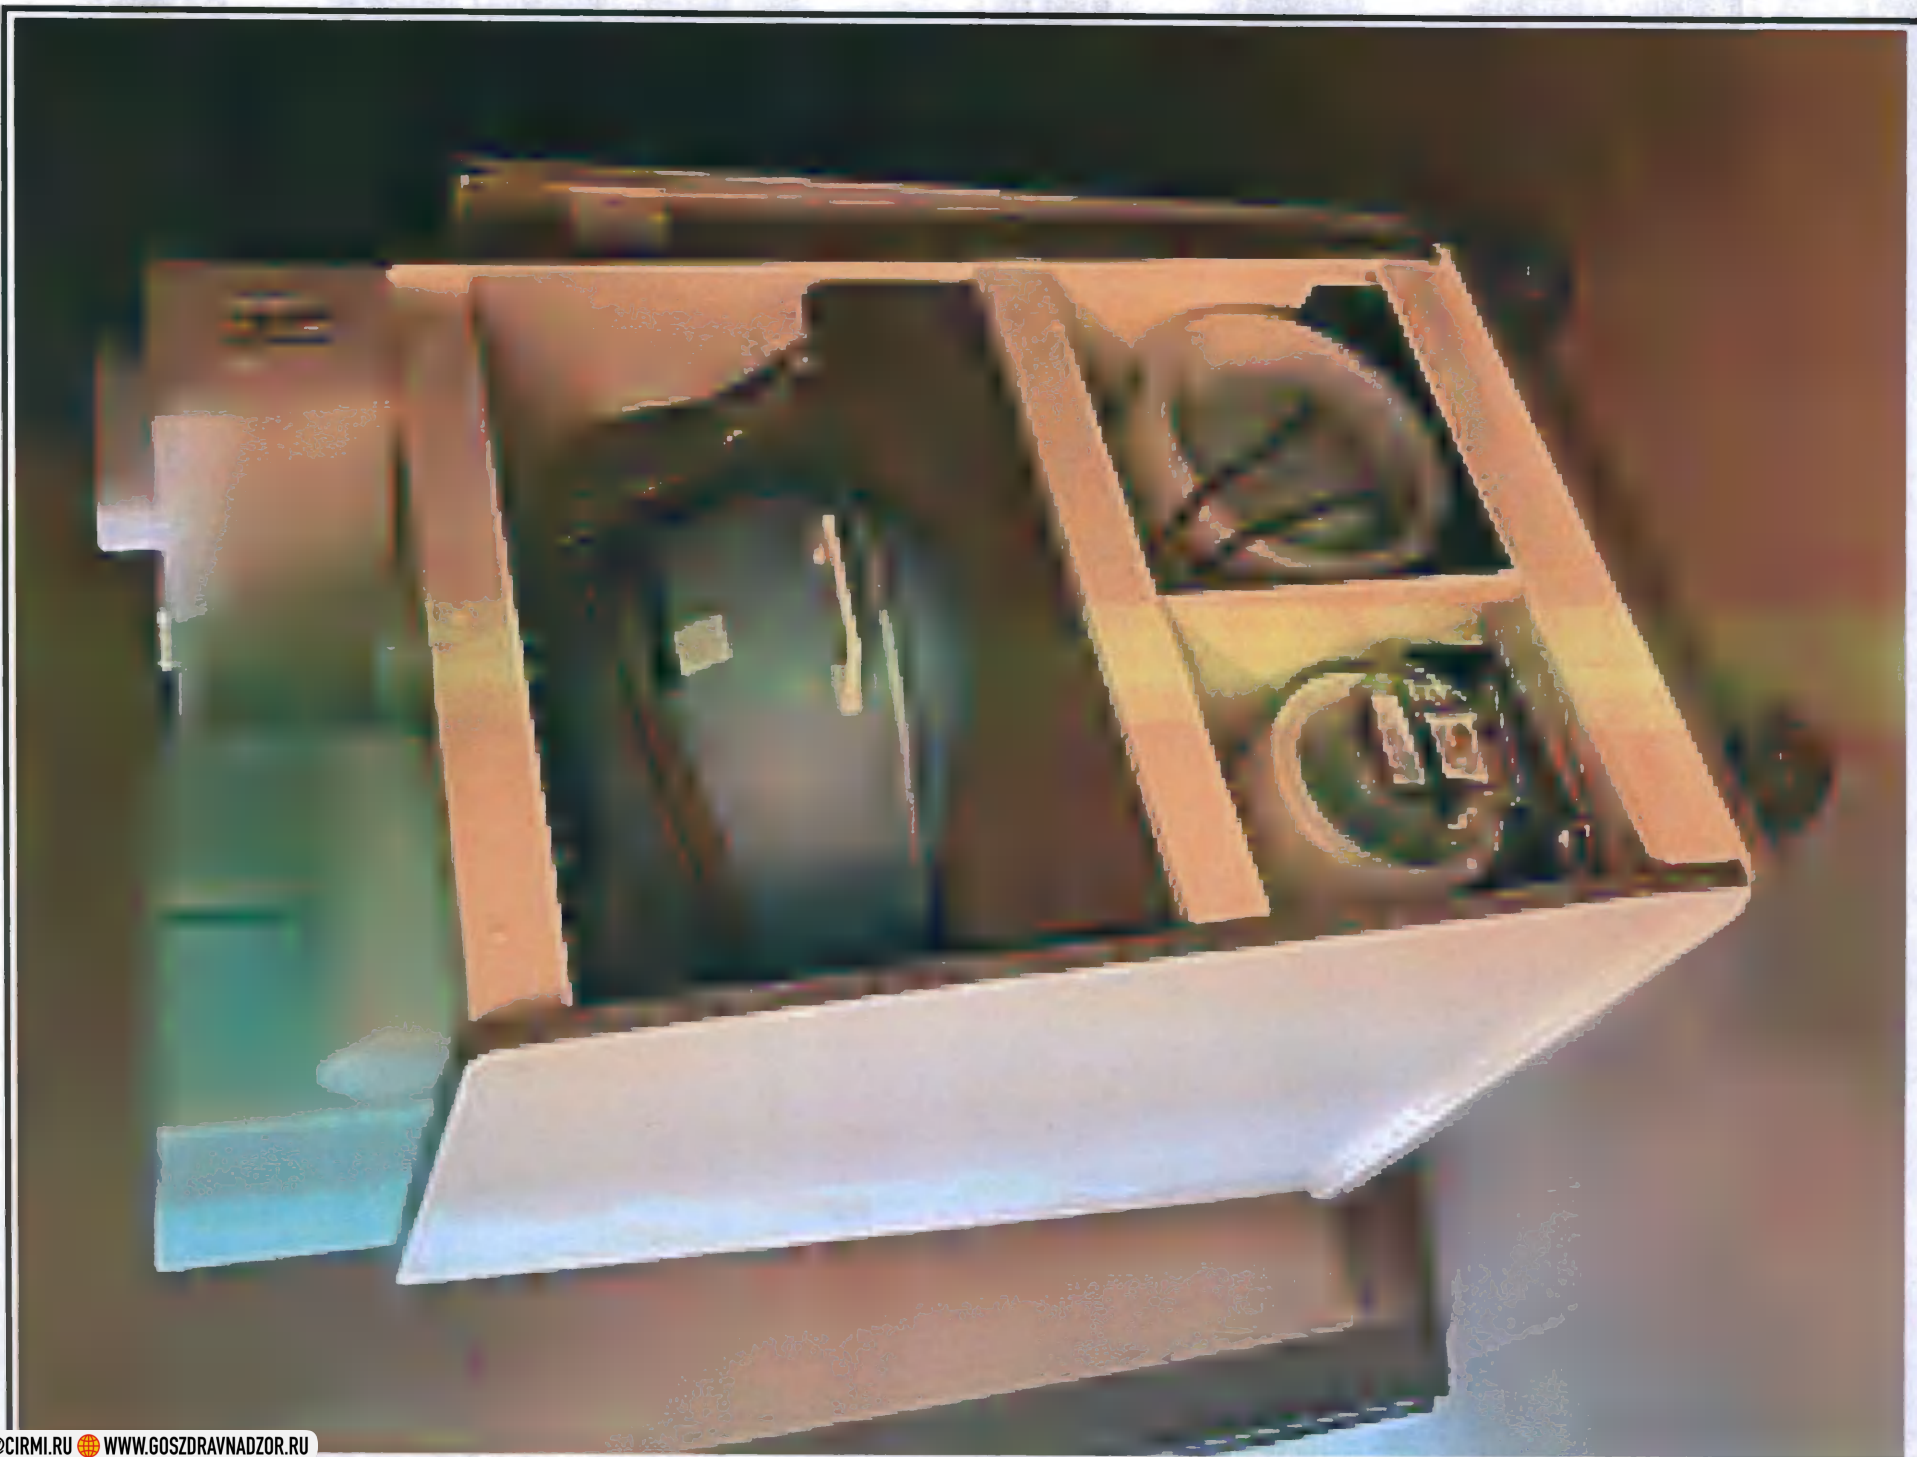

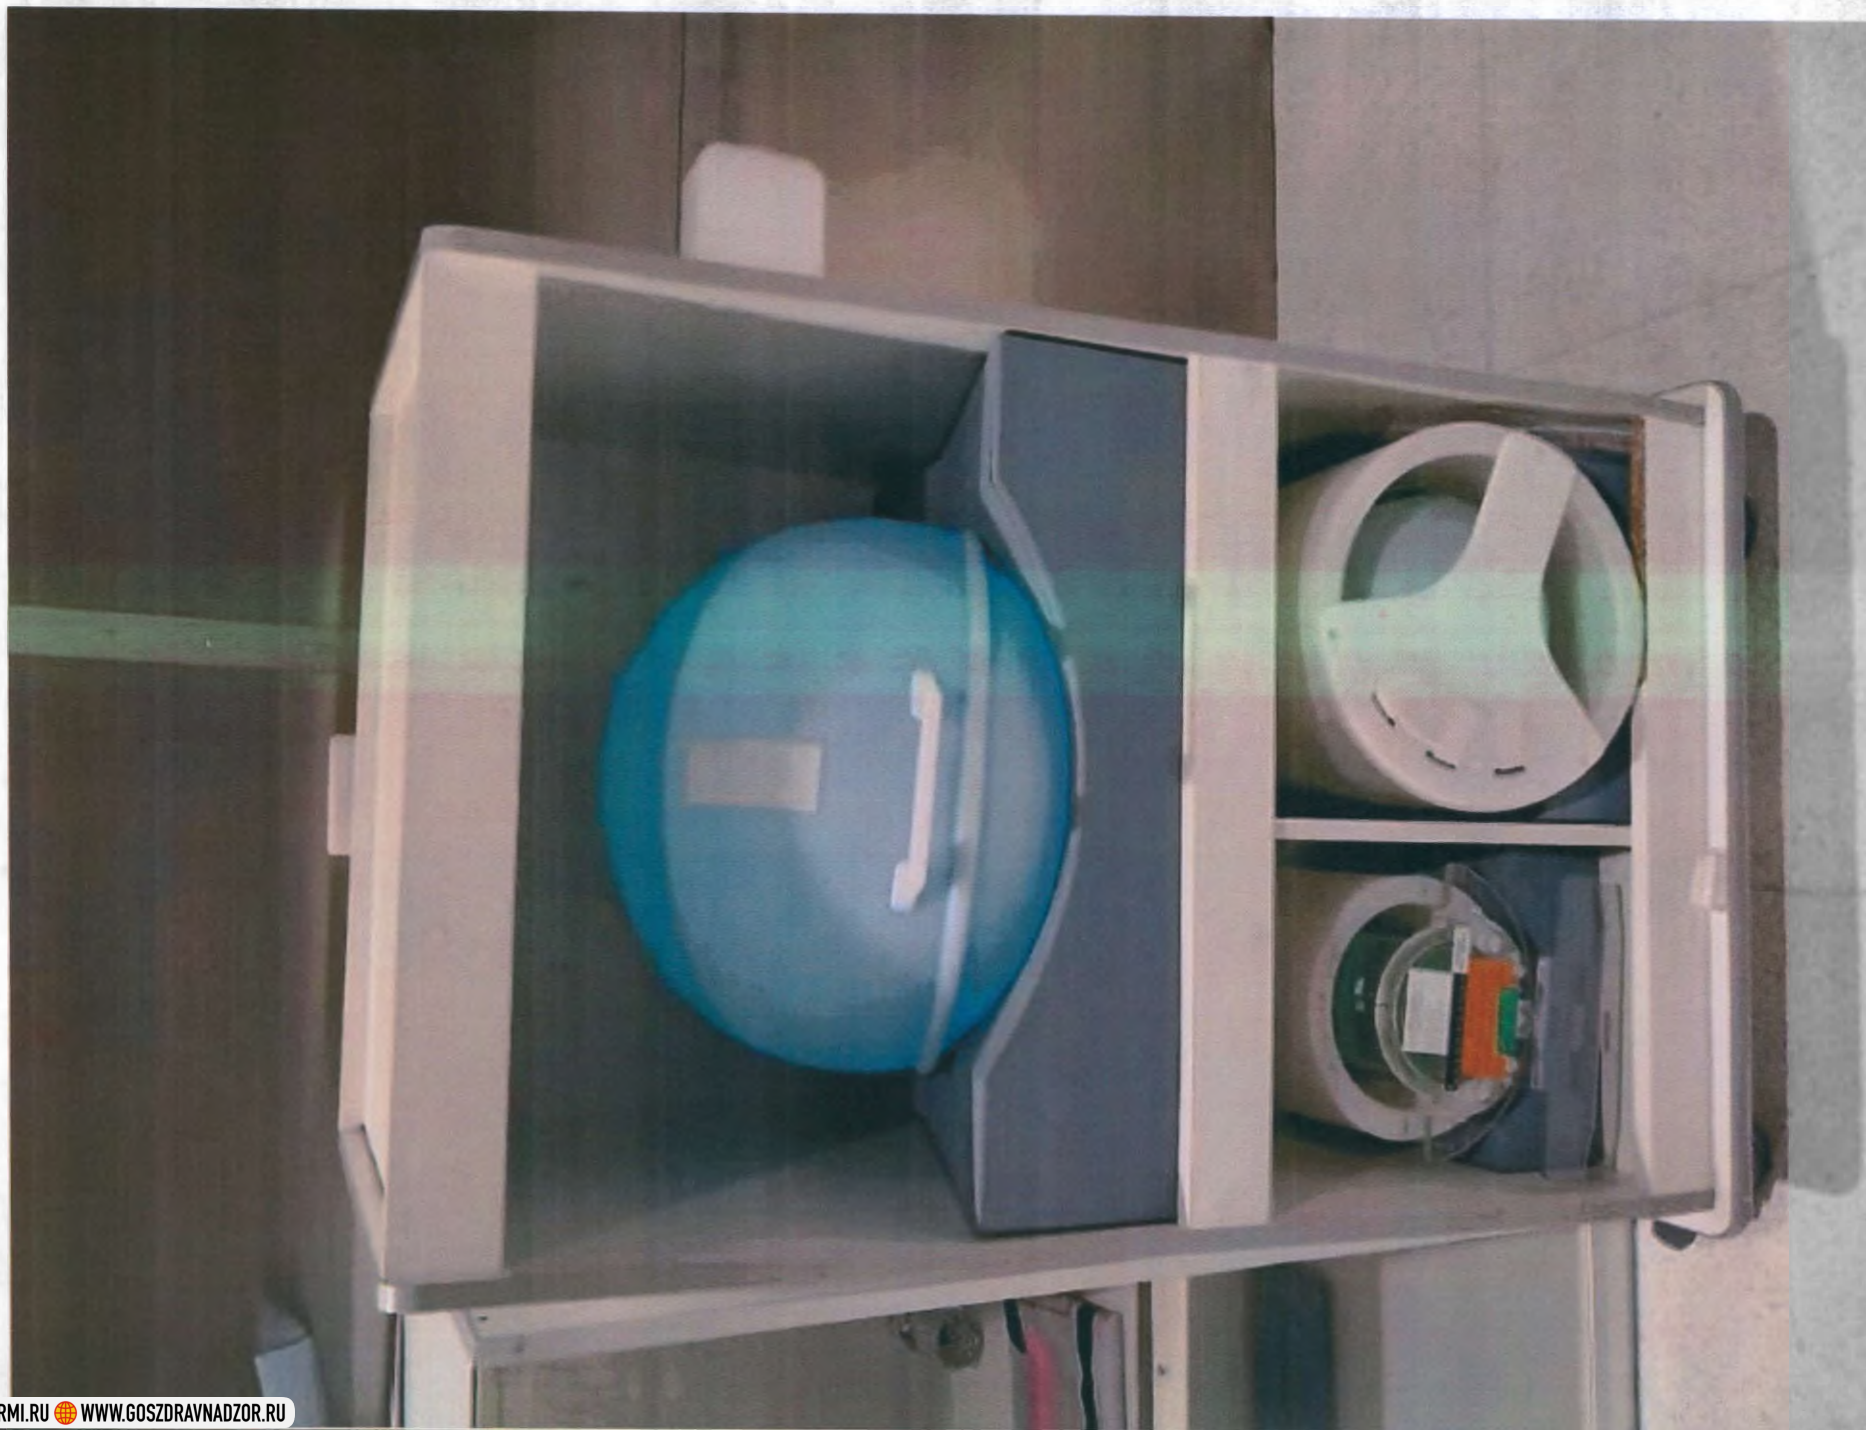

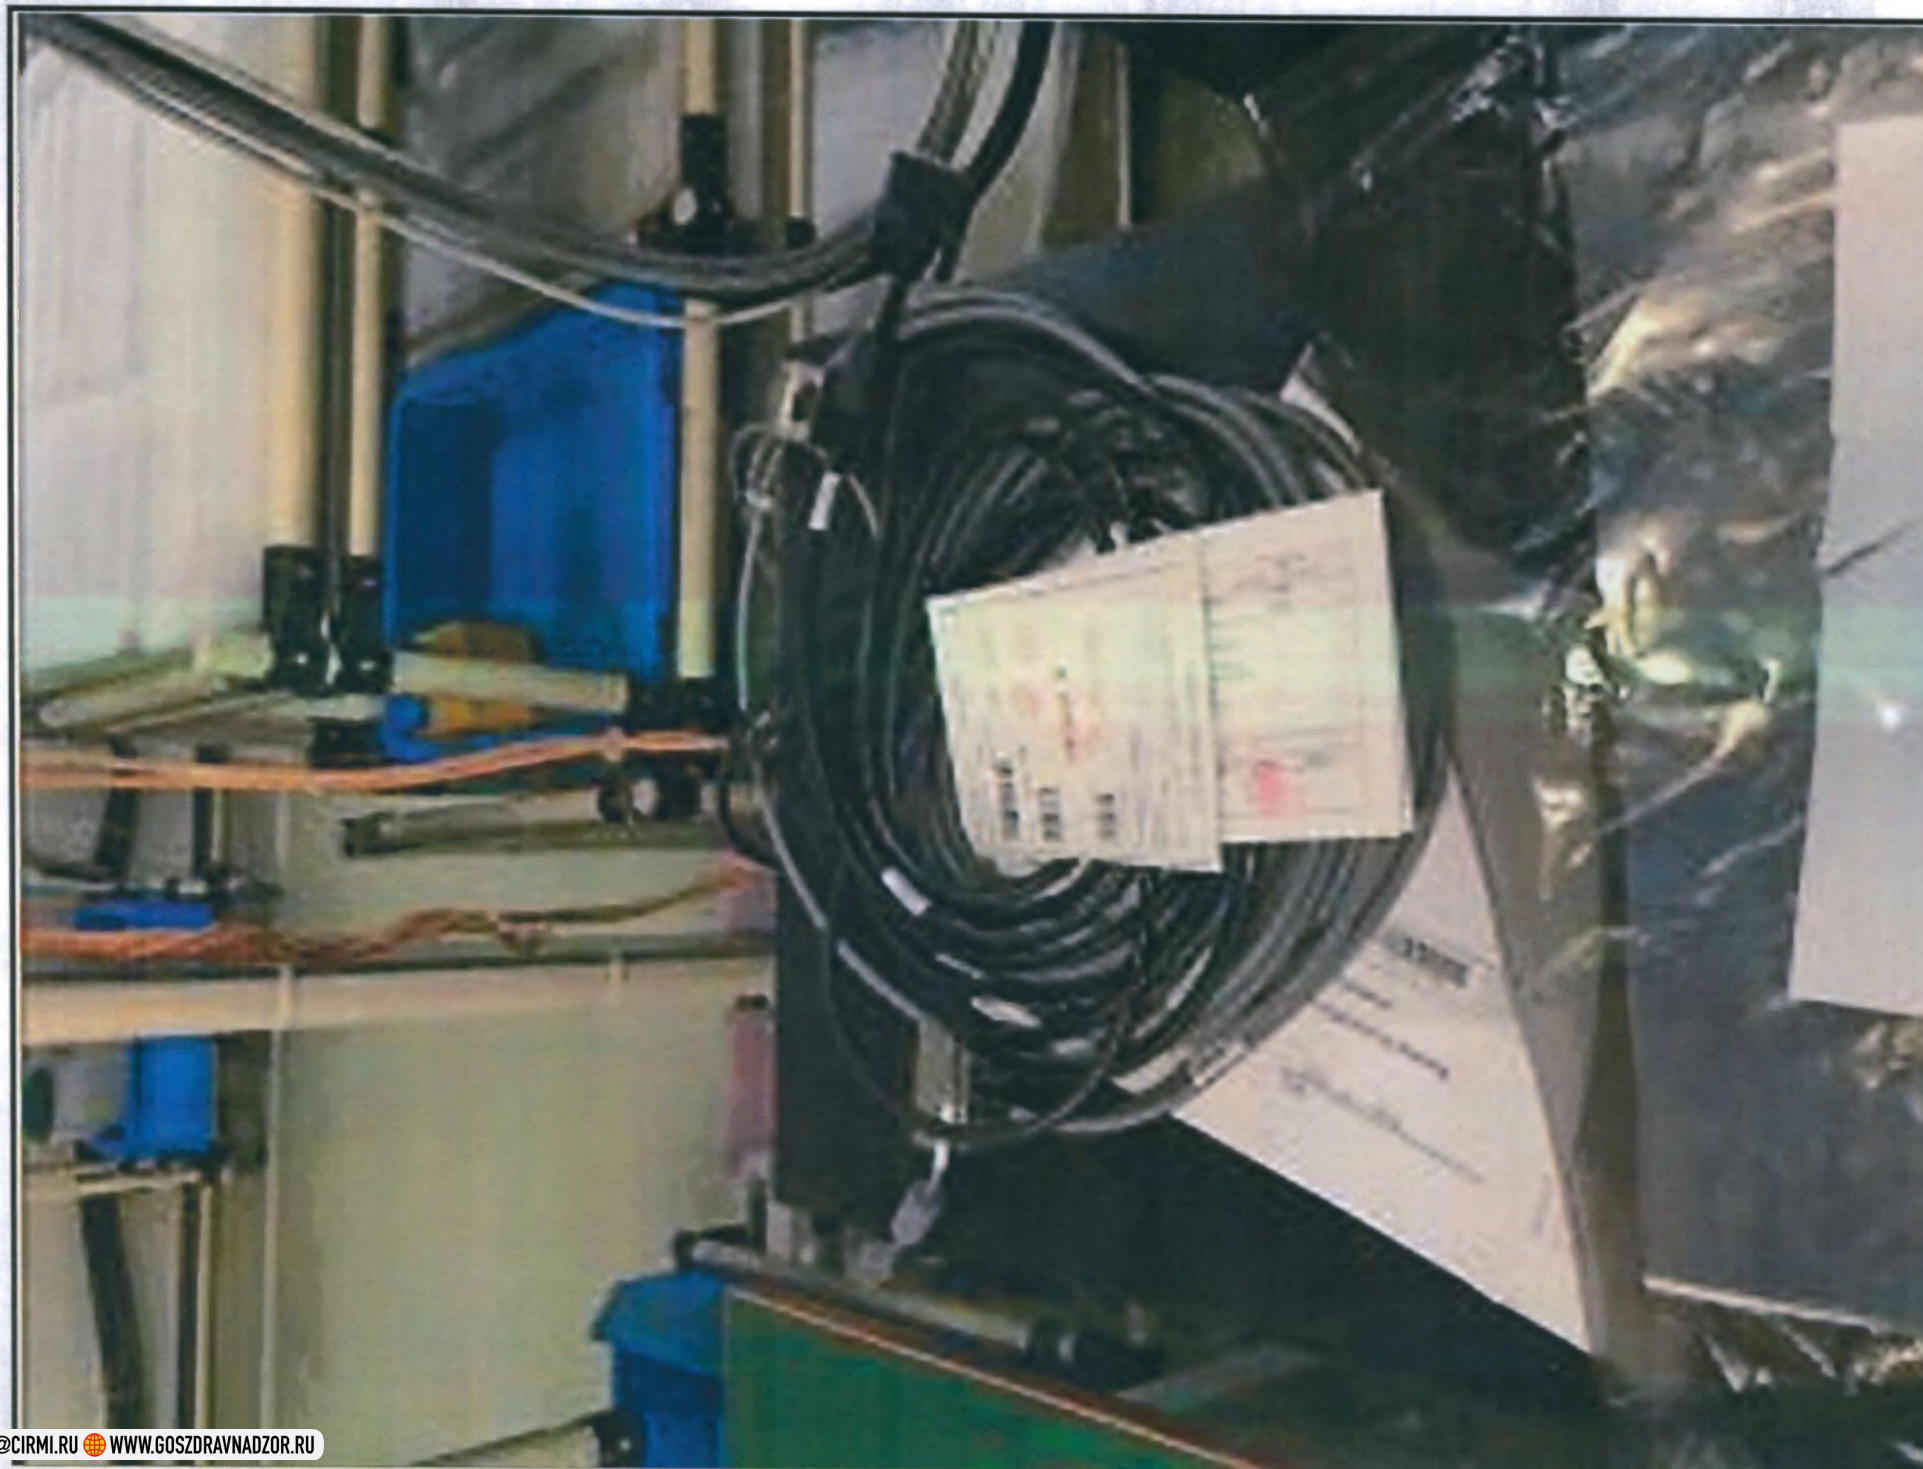


25. Кабели силовые (не более 200 шт.).

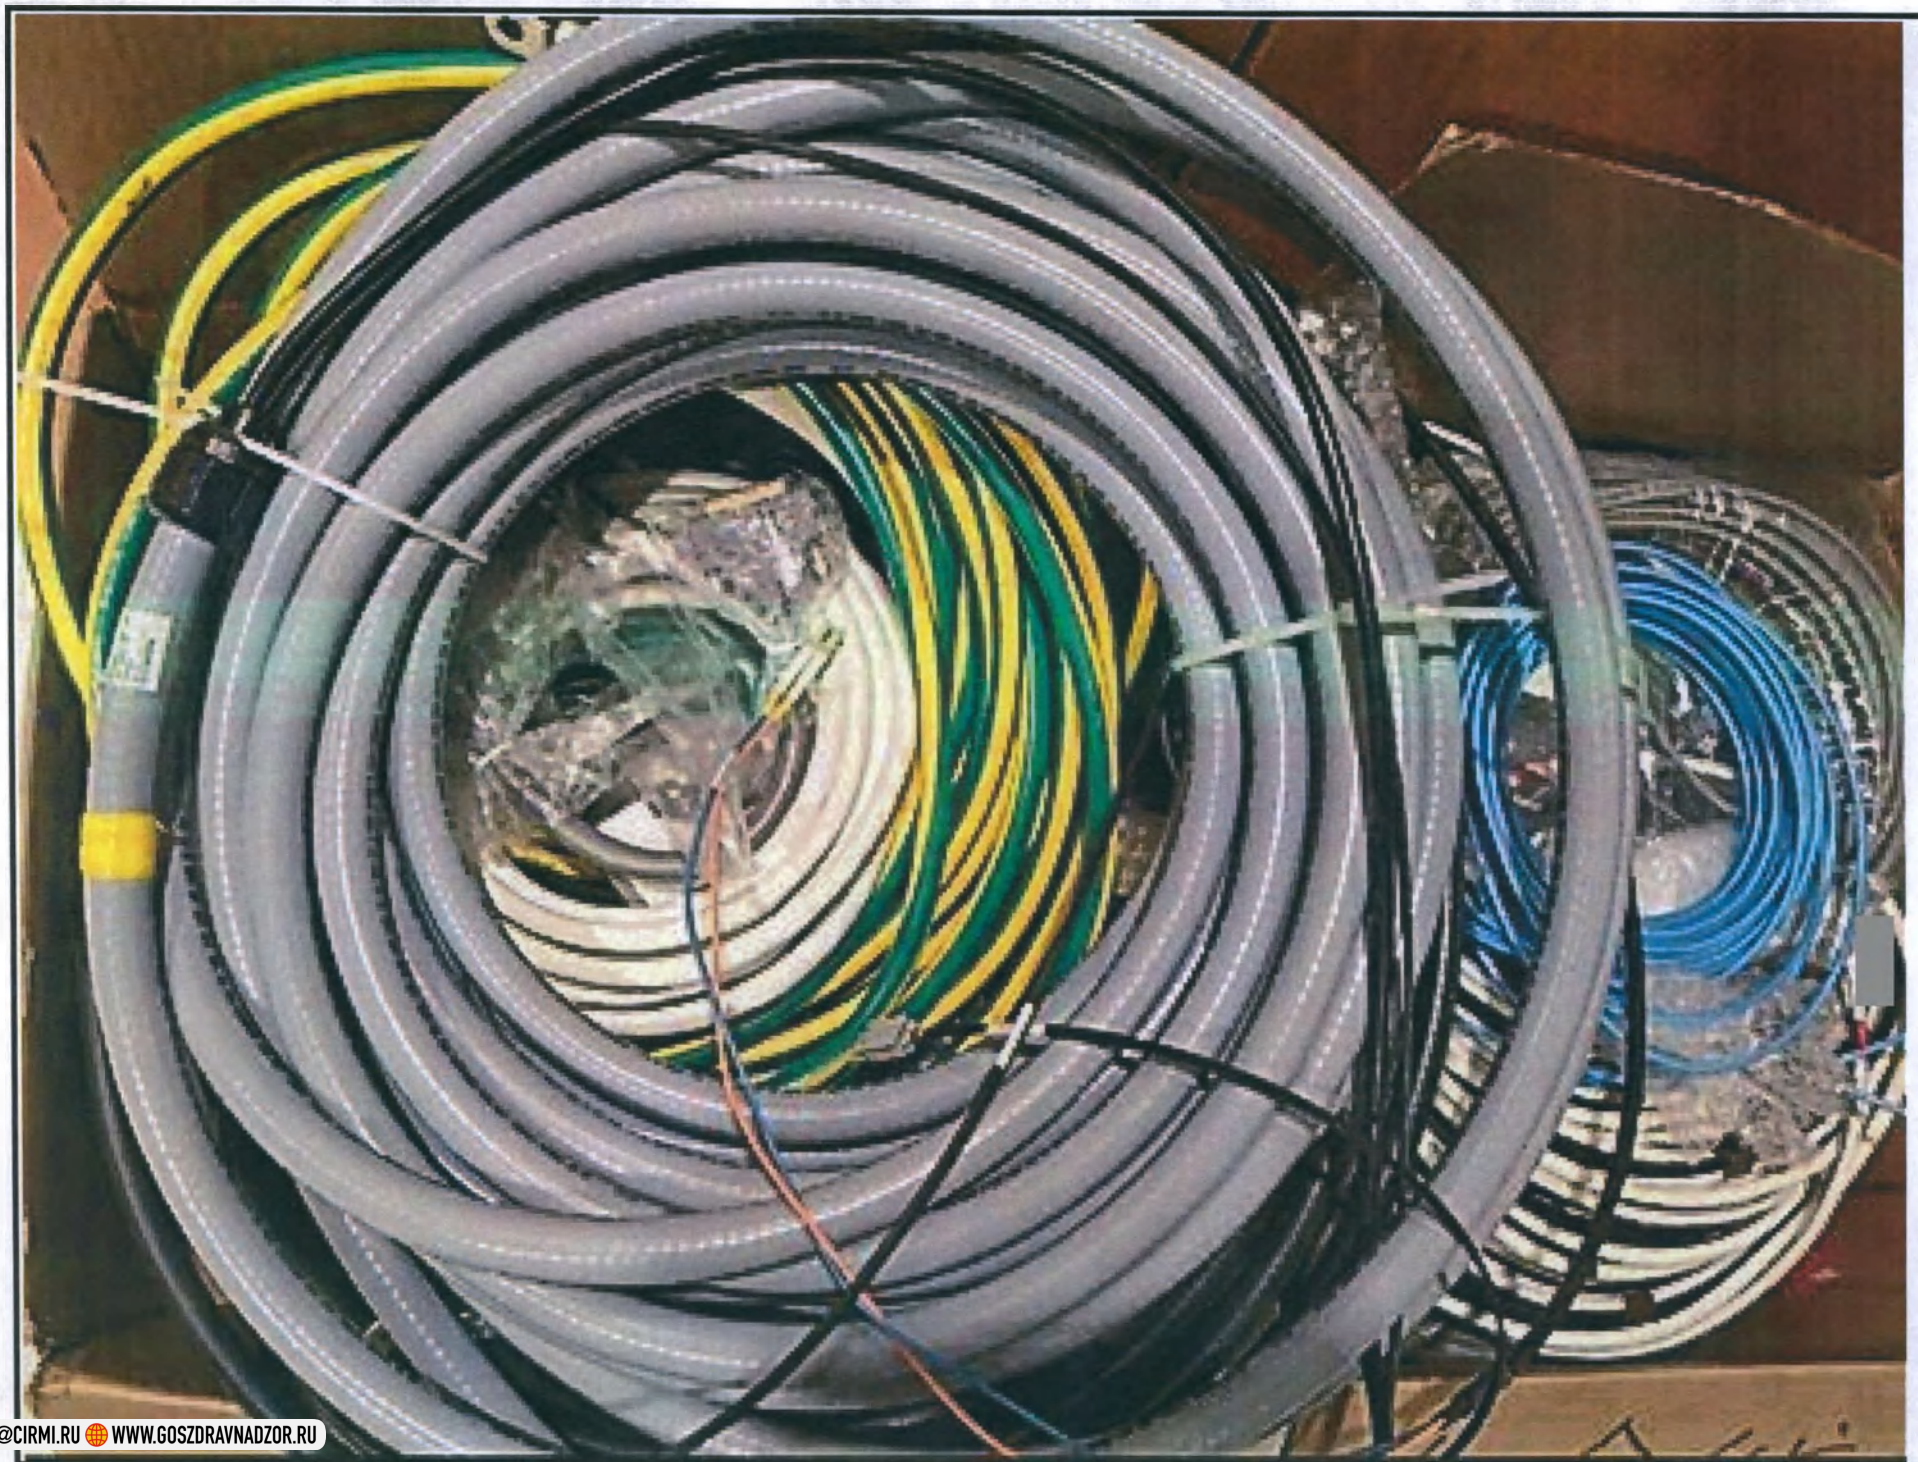




25. Кабели силовые (не более 200 шт.).

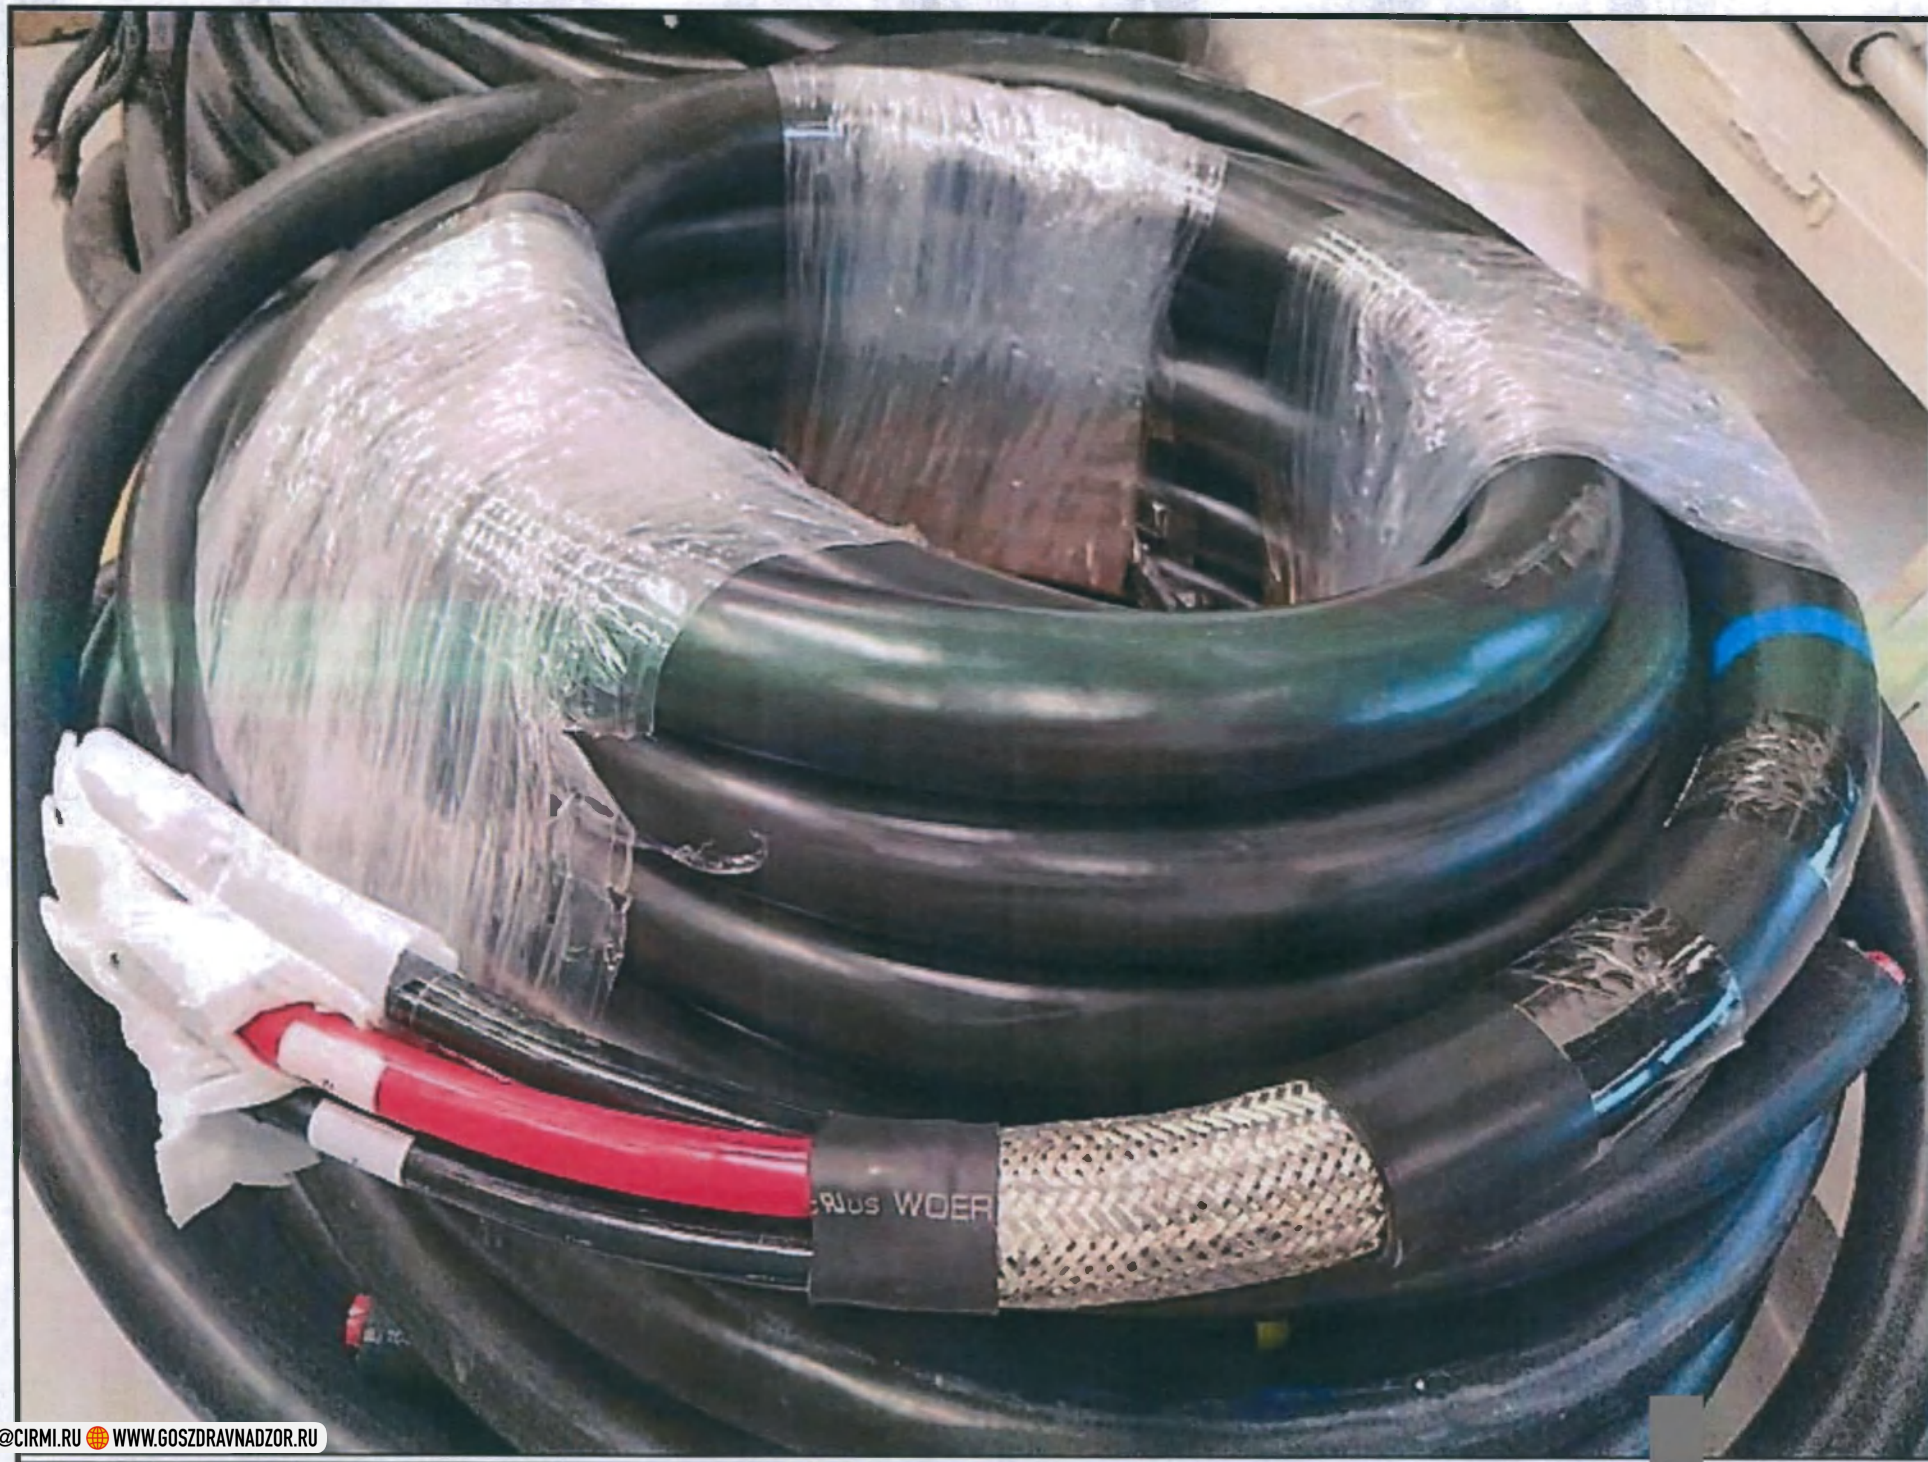

25. Кабели силовые (не более 200 шт.).

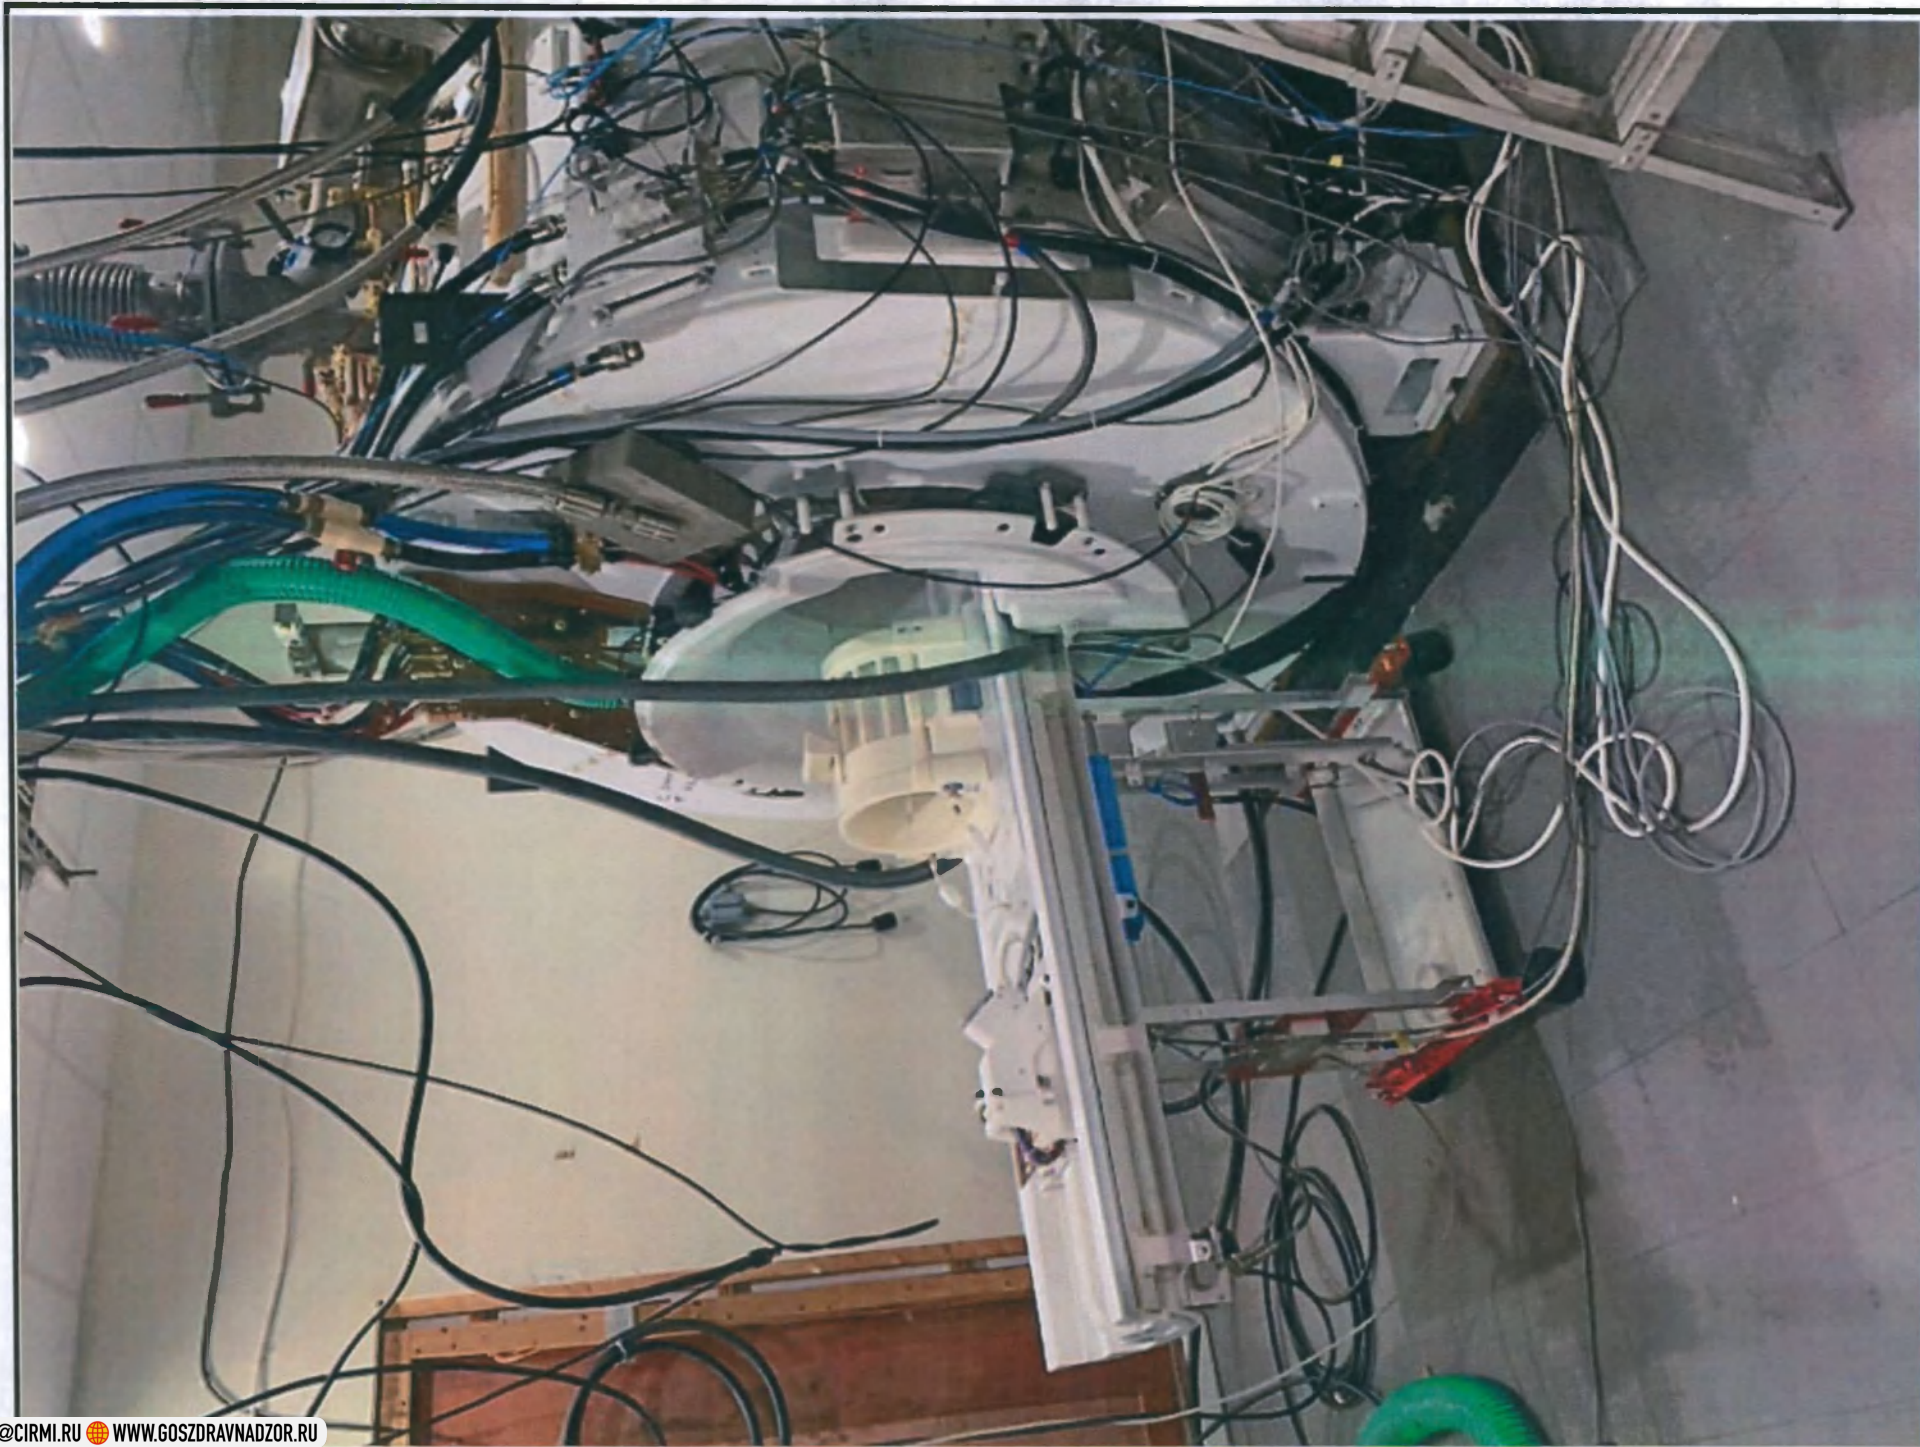


26. Кабели оптические для передачи информации (не более 30 шт.).




26. Кабели оптические для передачи информации (не более 30 шт.).



27. Кабели соединительные (не более 200 шт.).

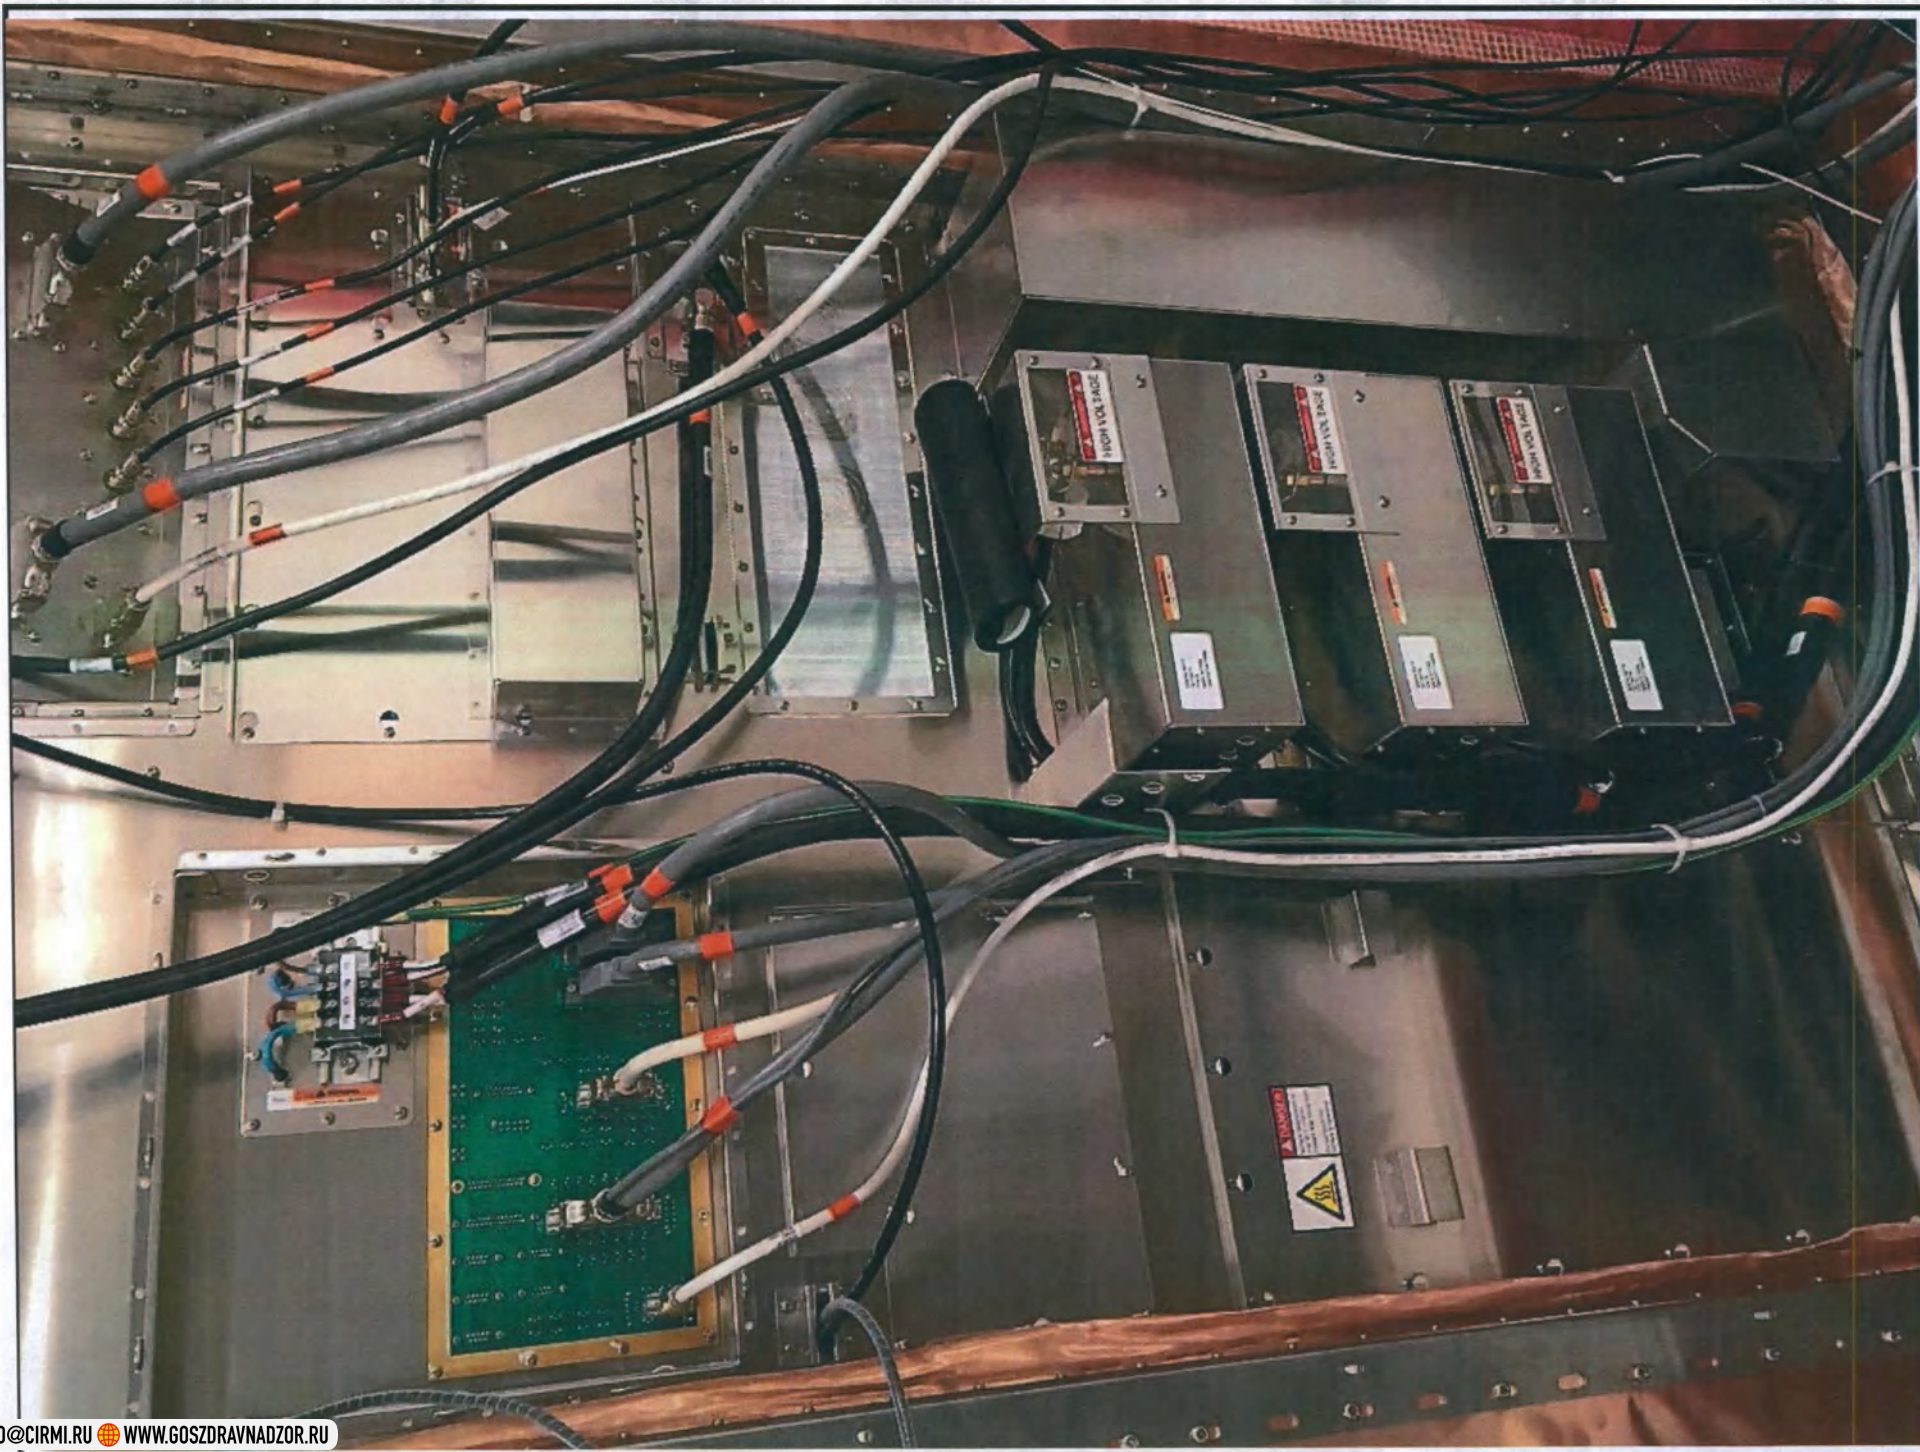


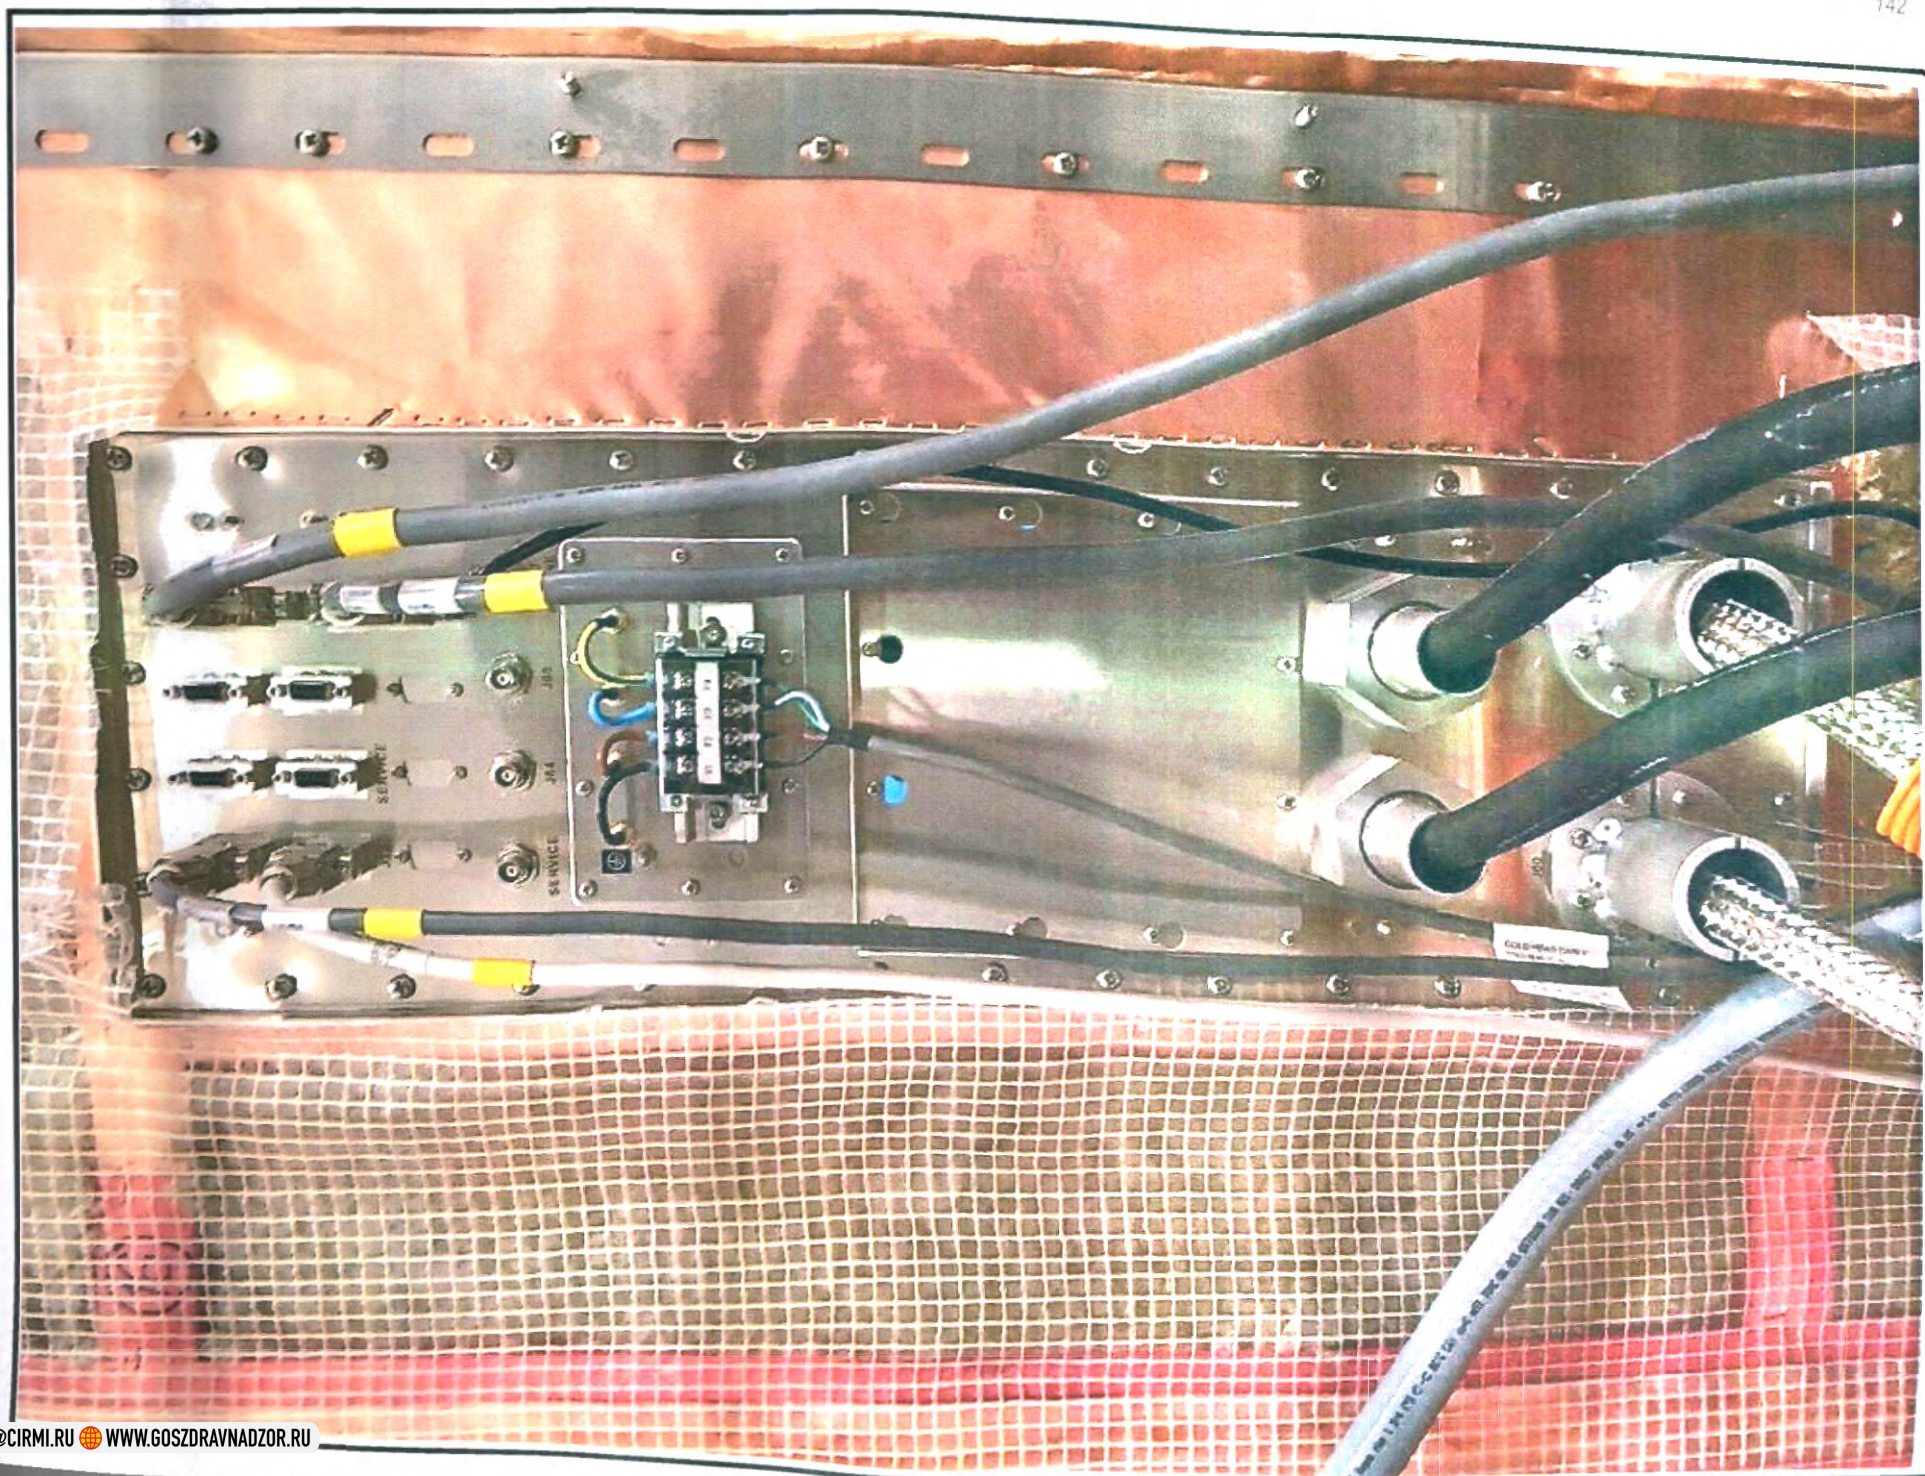

28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

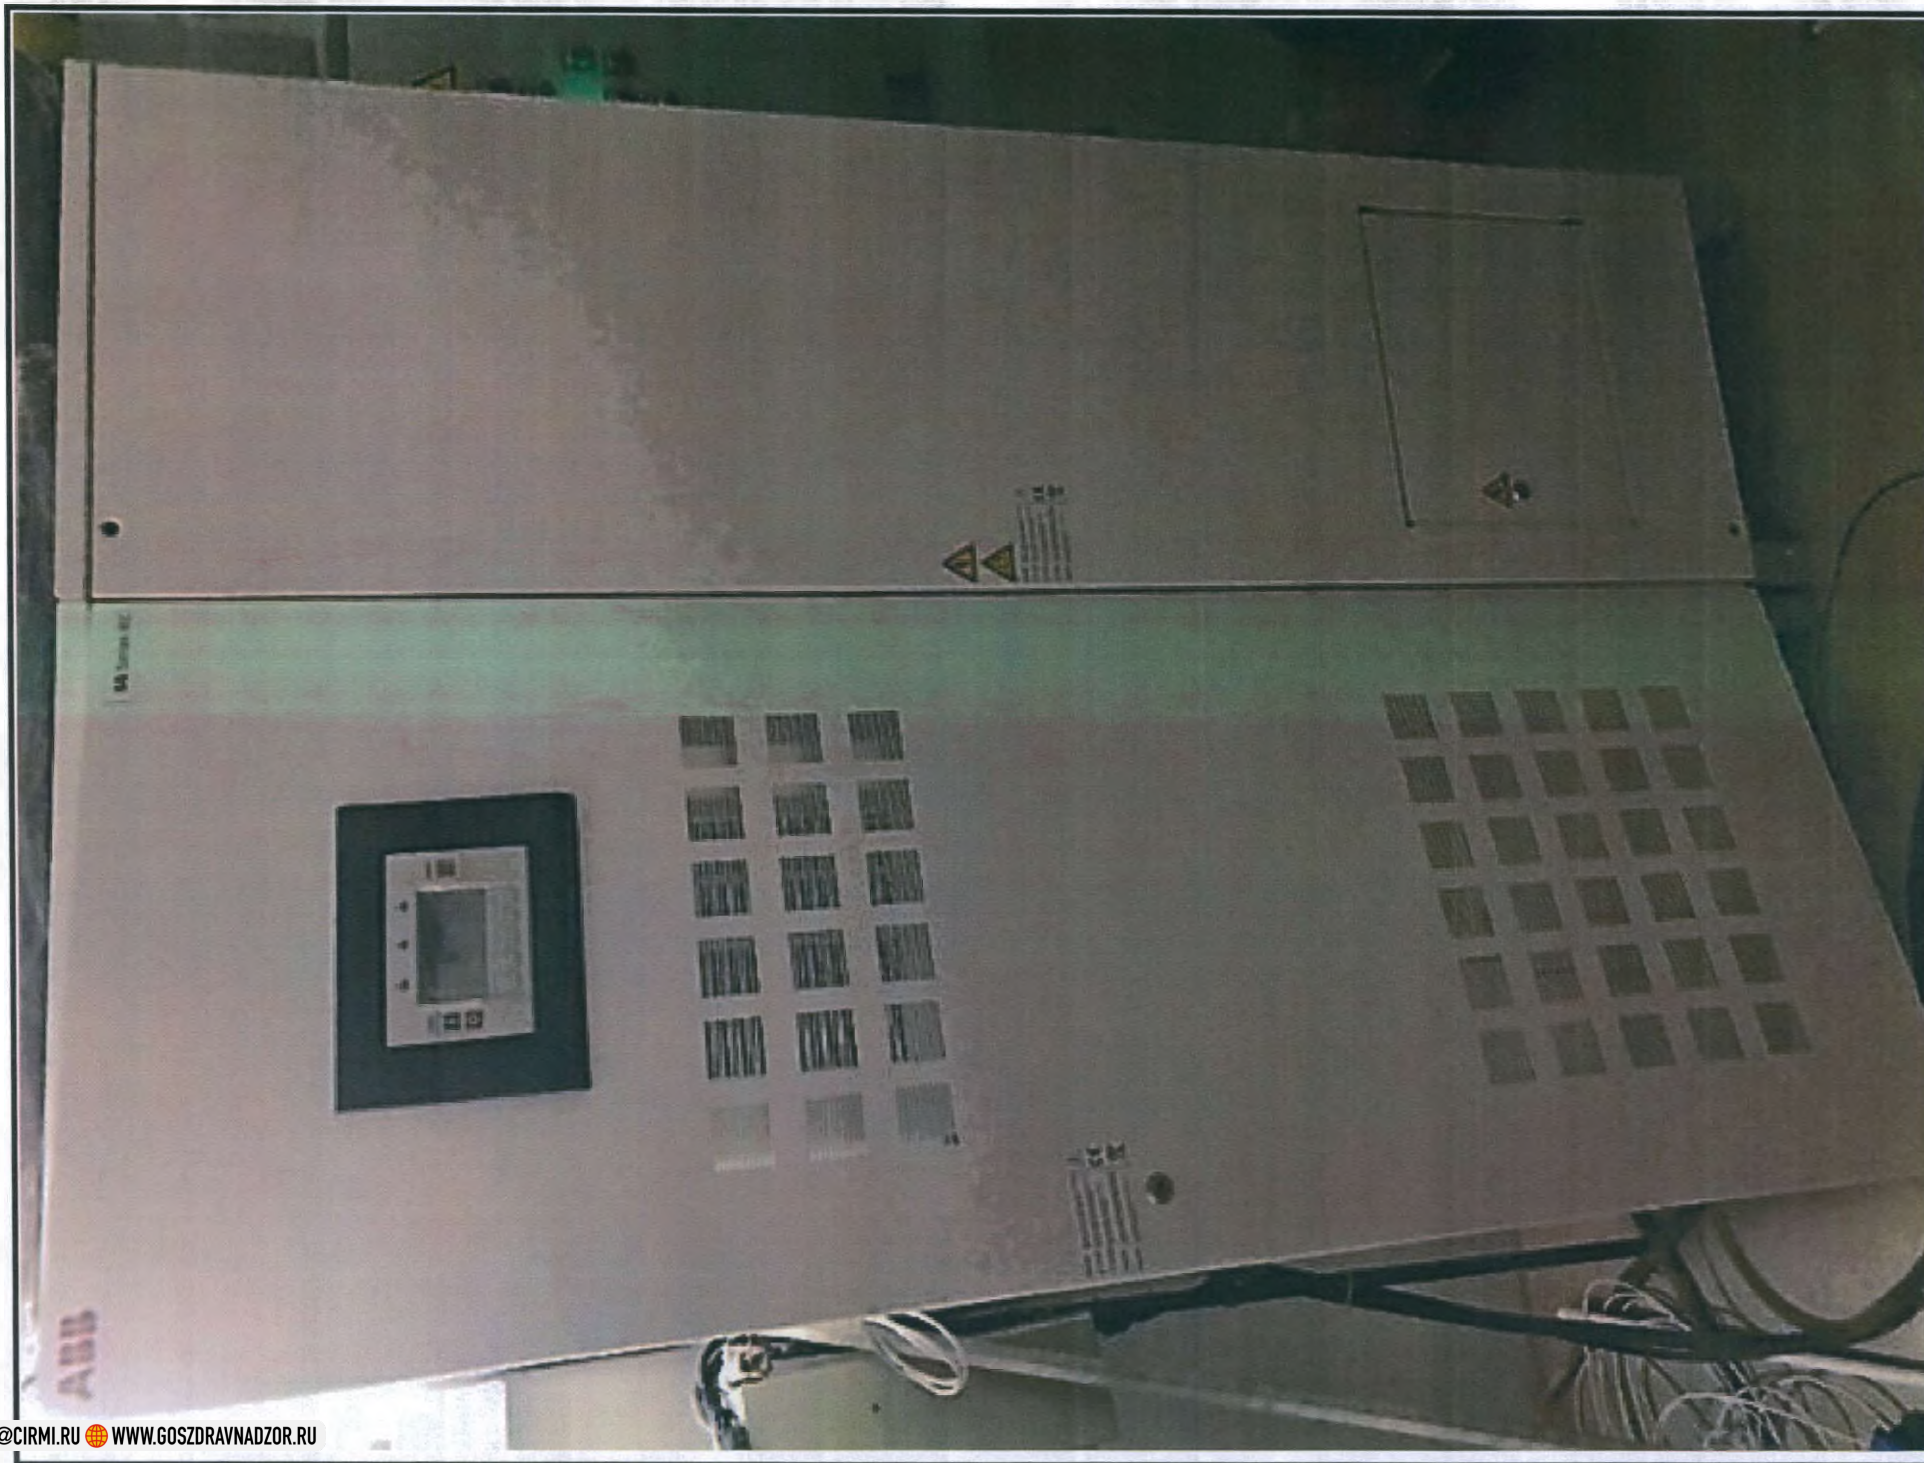

28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).





28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



28. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).







29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).




29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).

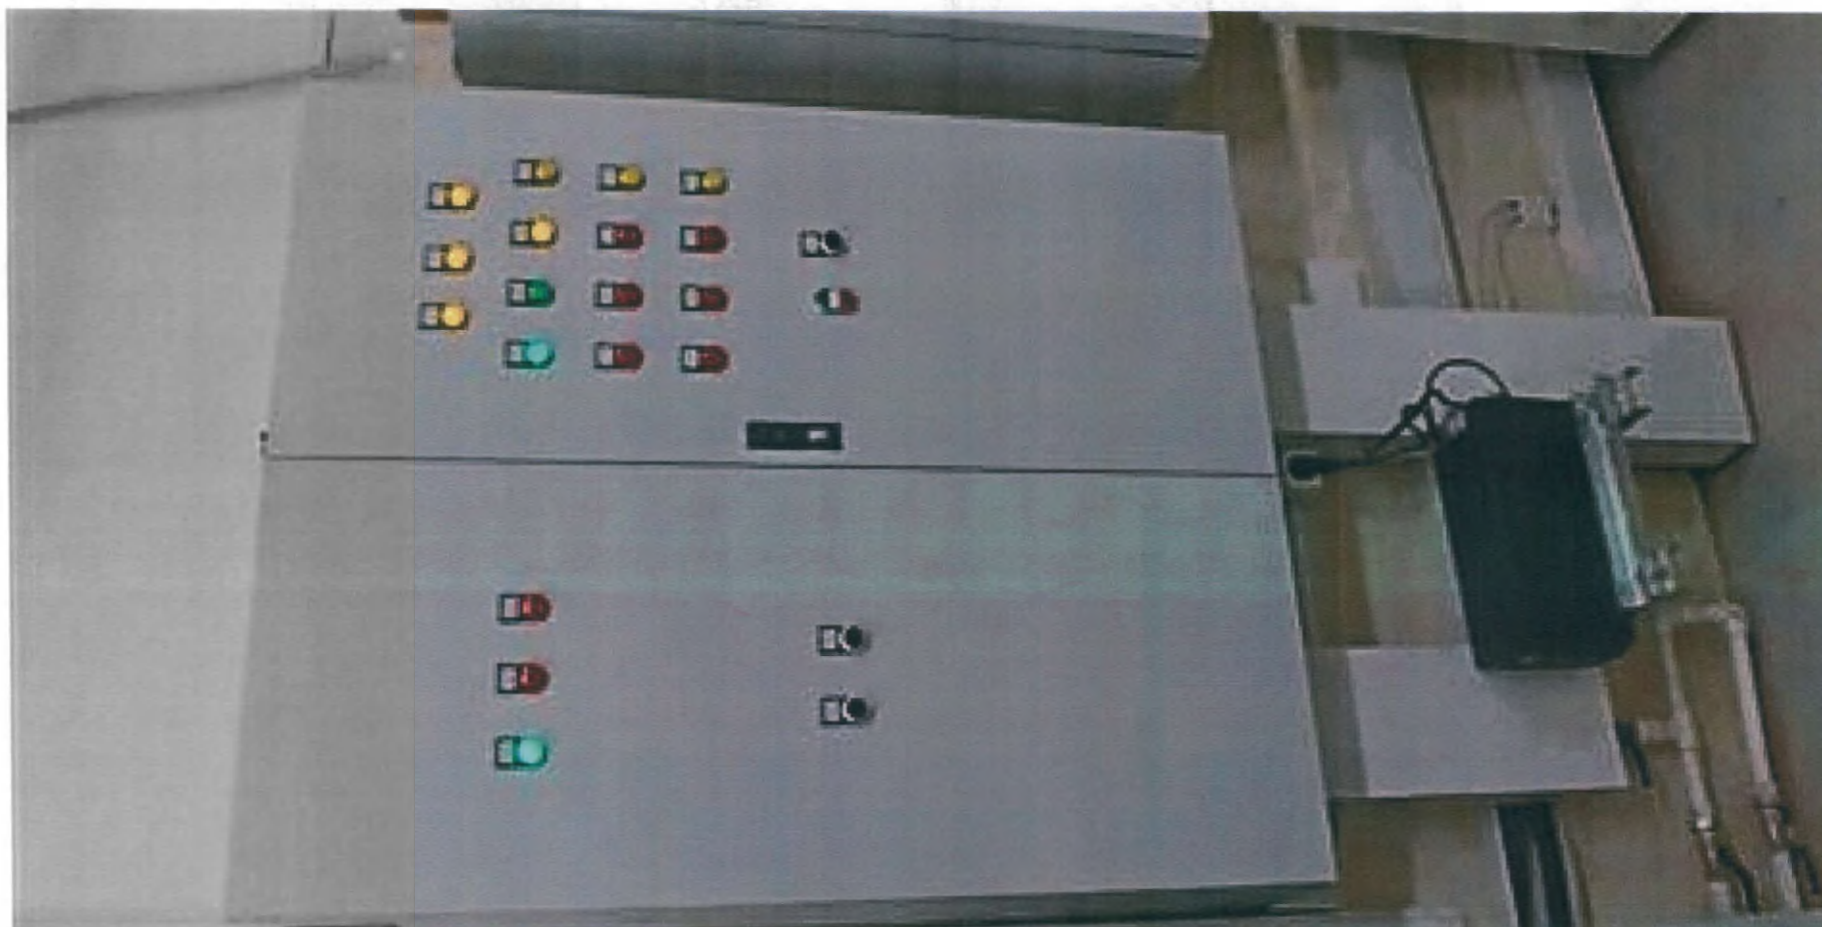

29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).

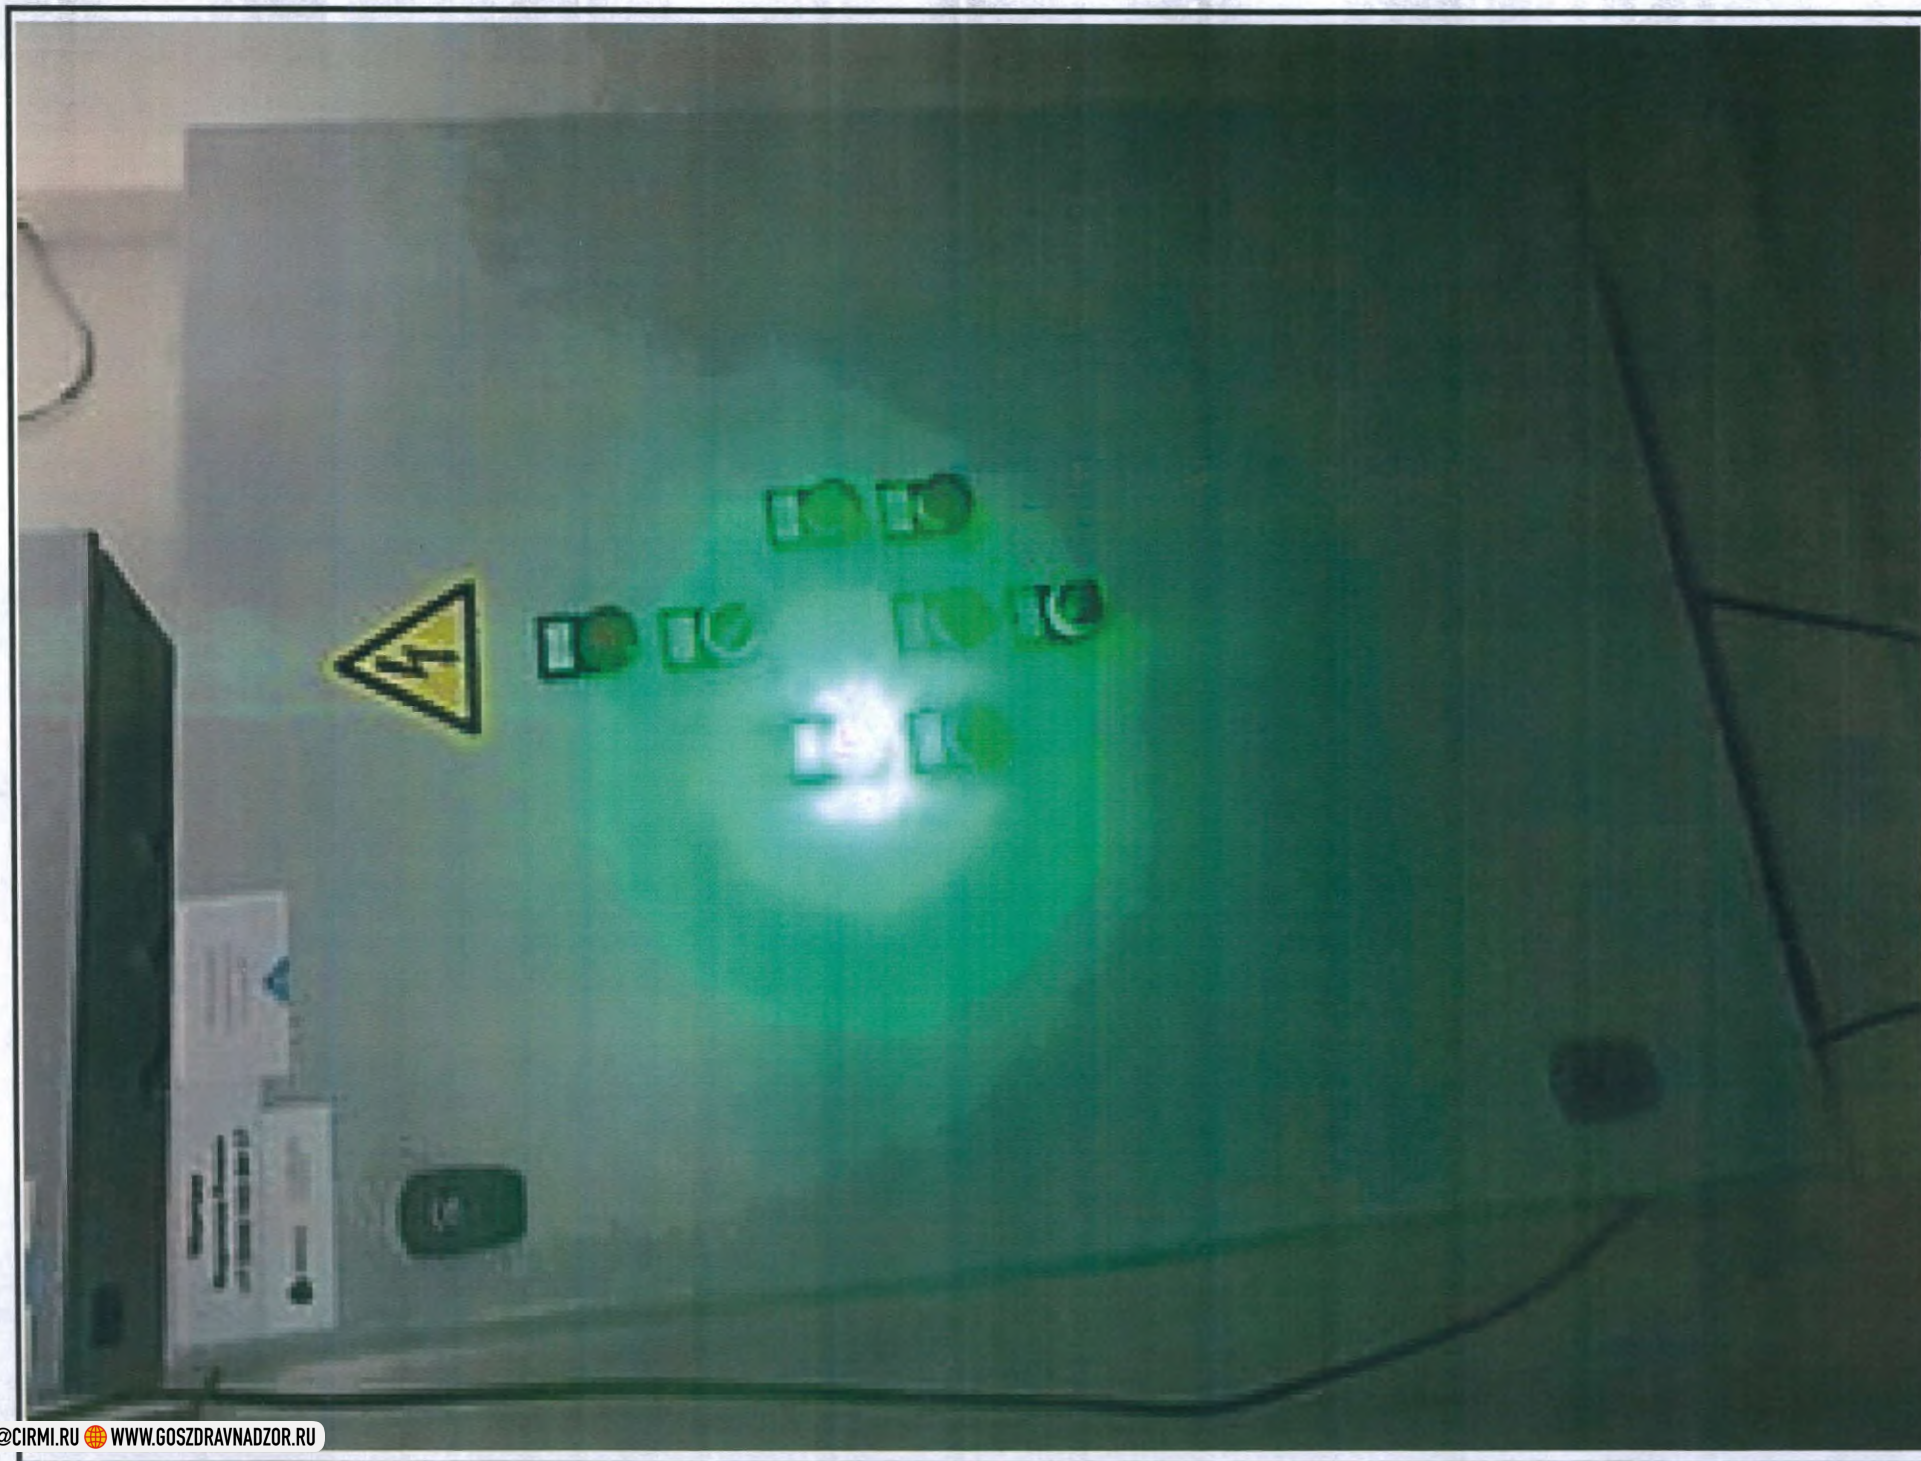


29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).

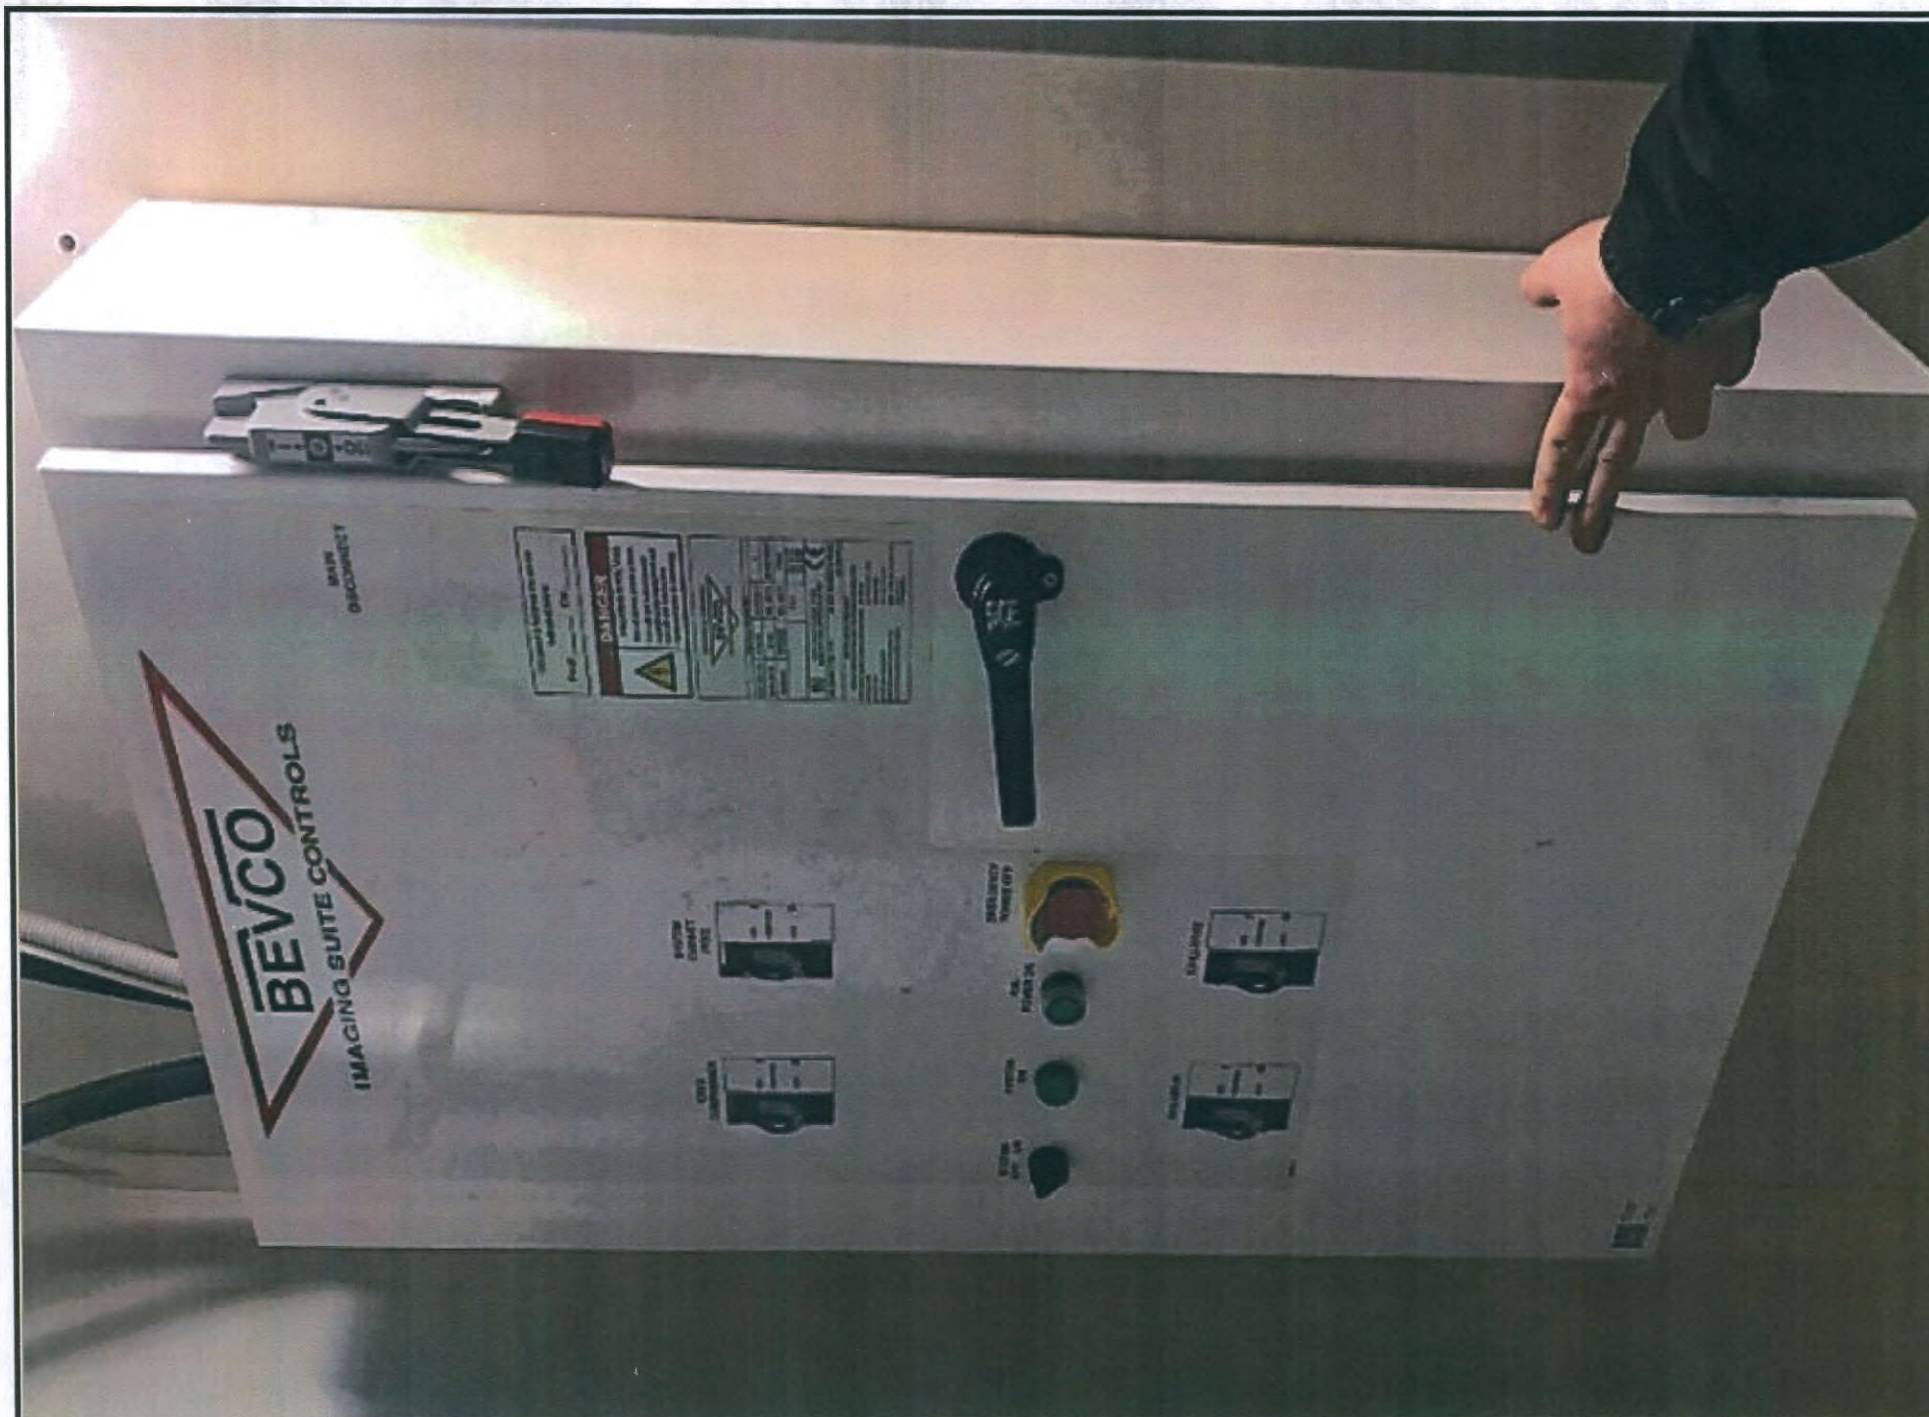

29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).



29. Щит главный распределительный (не более 5 шт.).

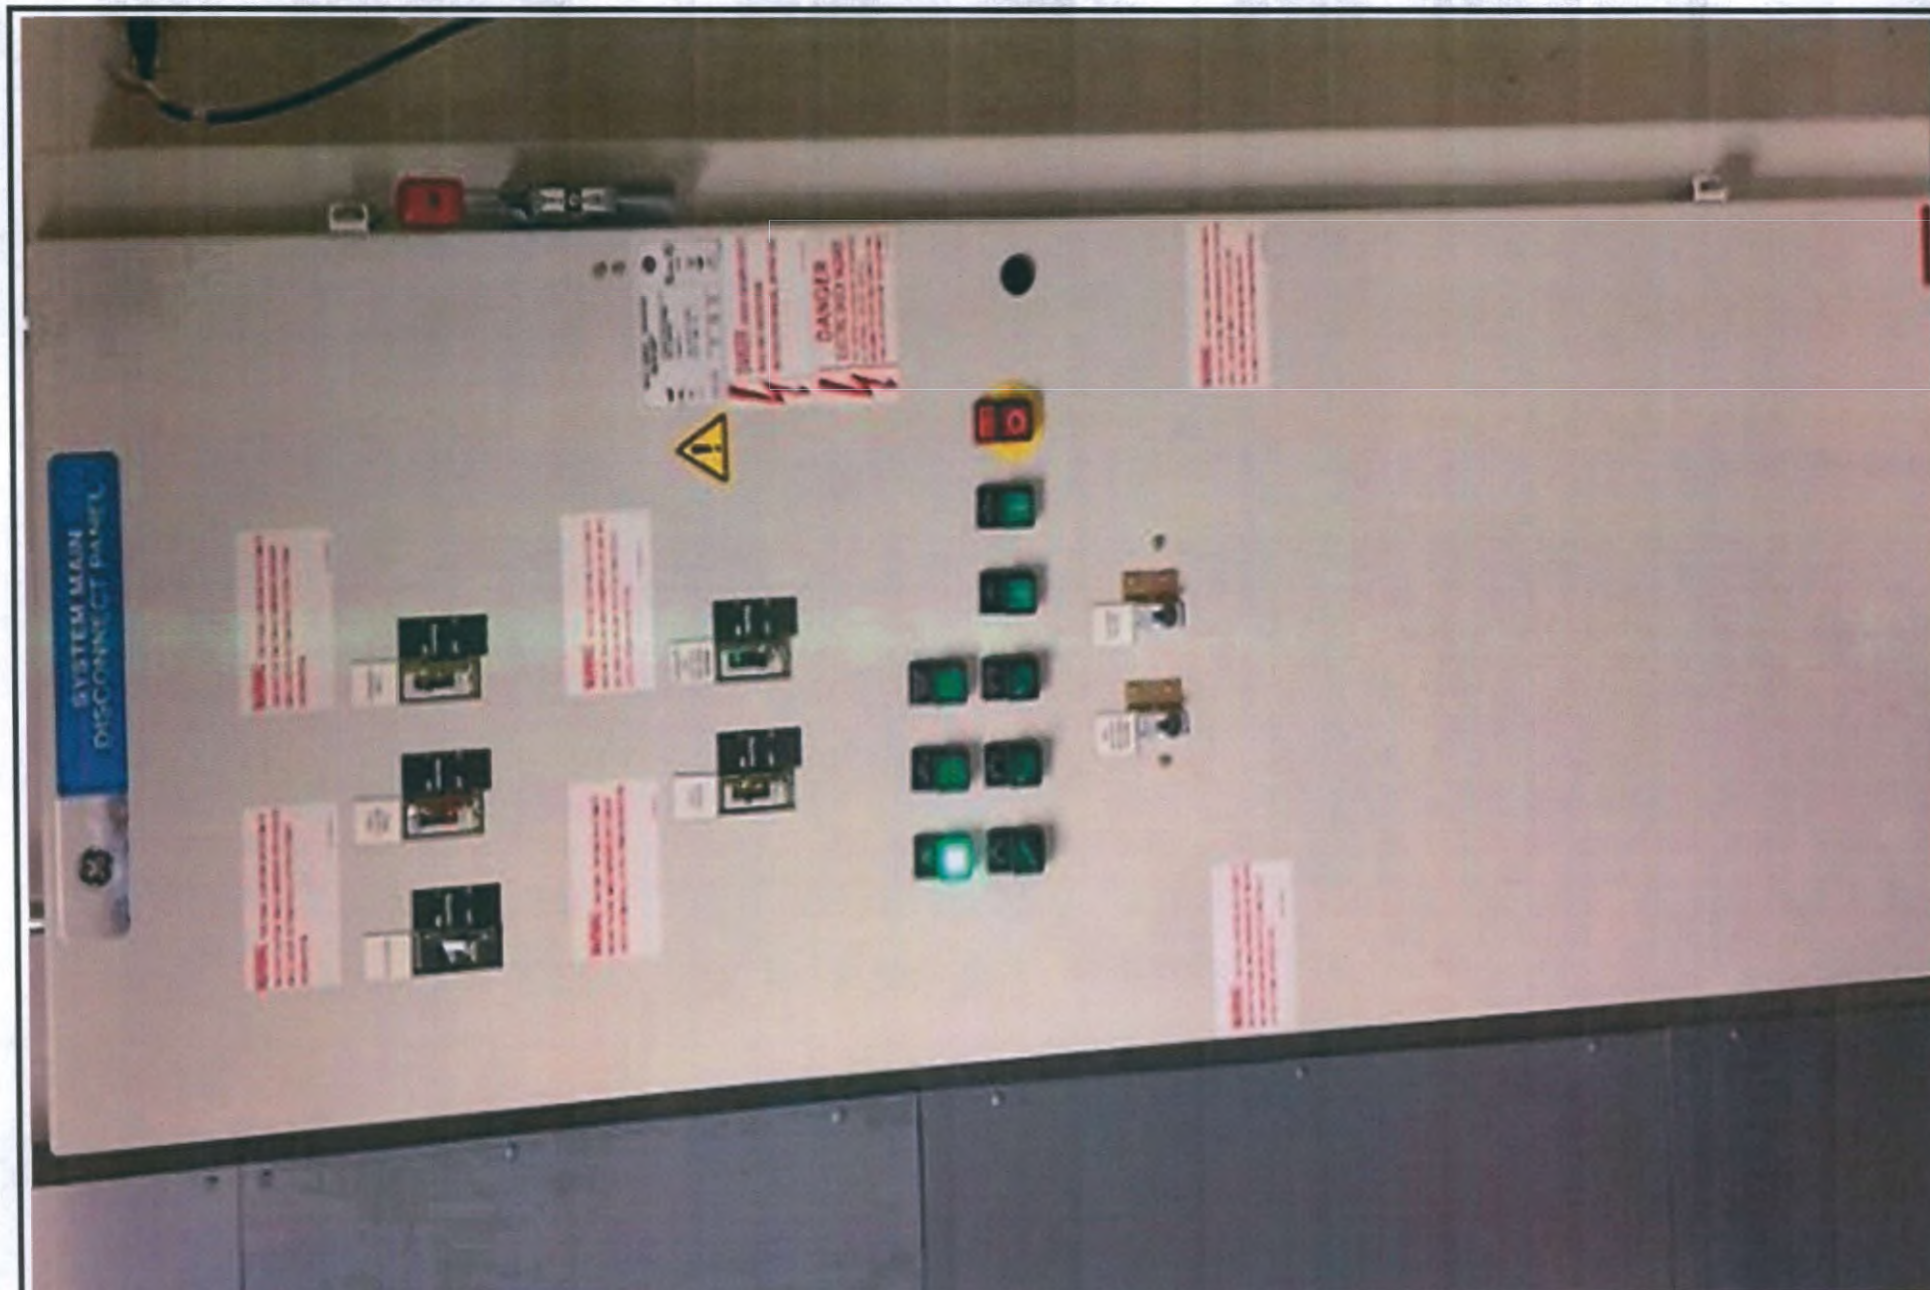




30. Тележки для перемещения шкафов электроники (не более 5шт.).



31. Виброакустические маты (не более 100 шт.).

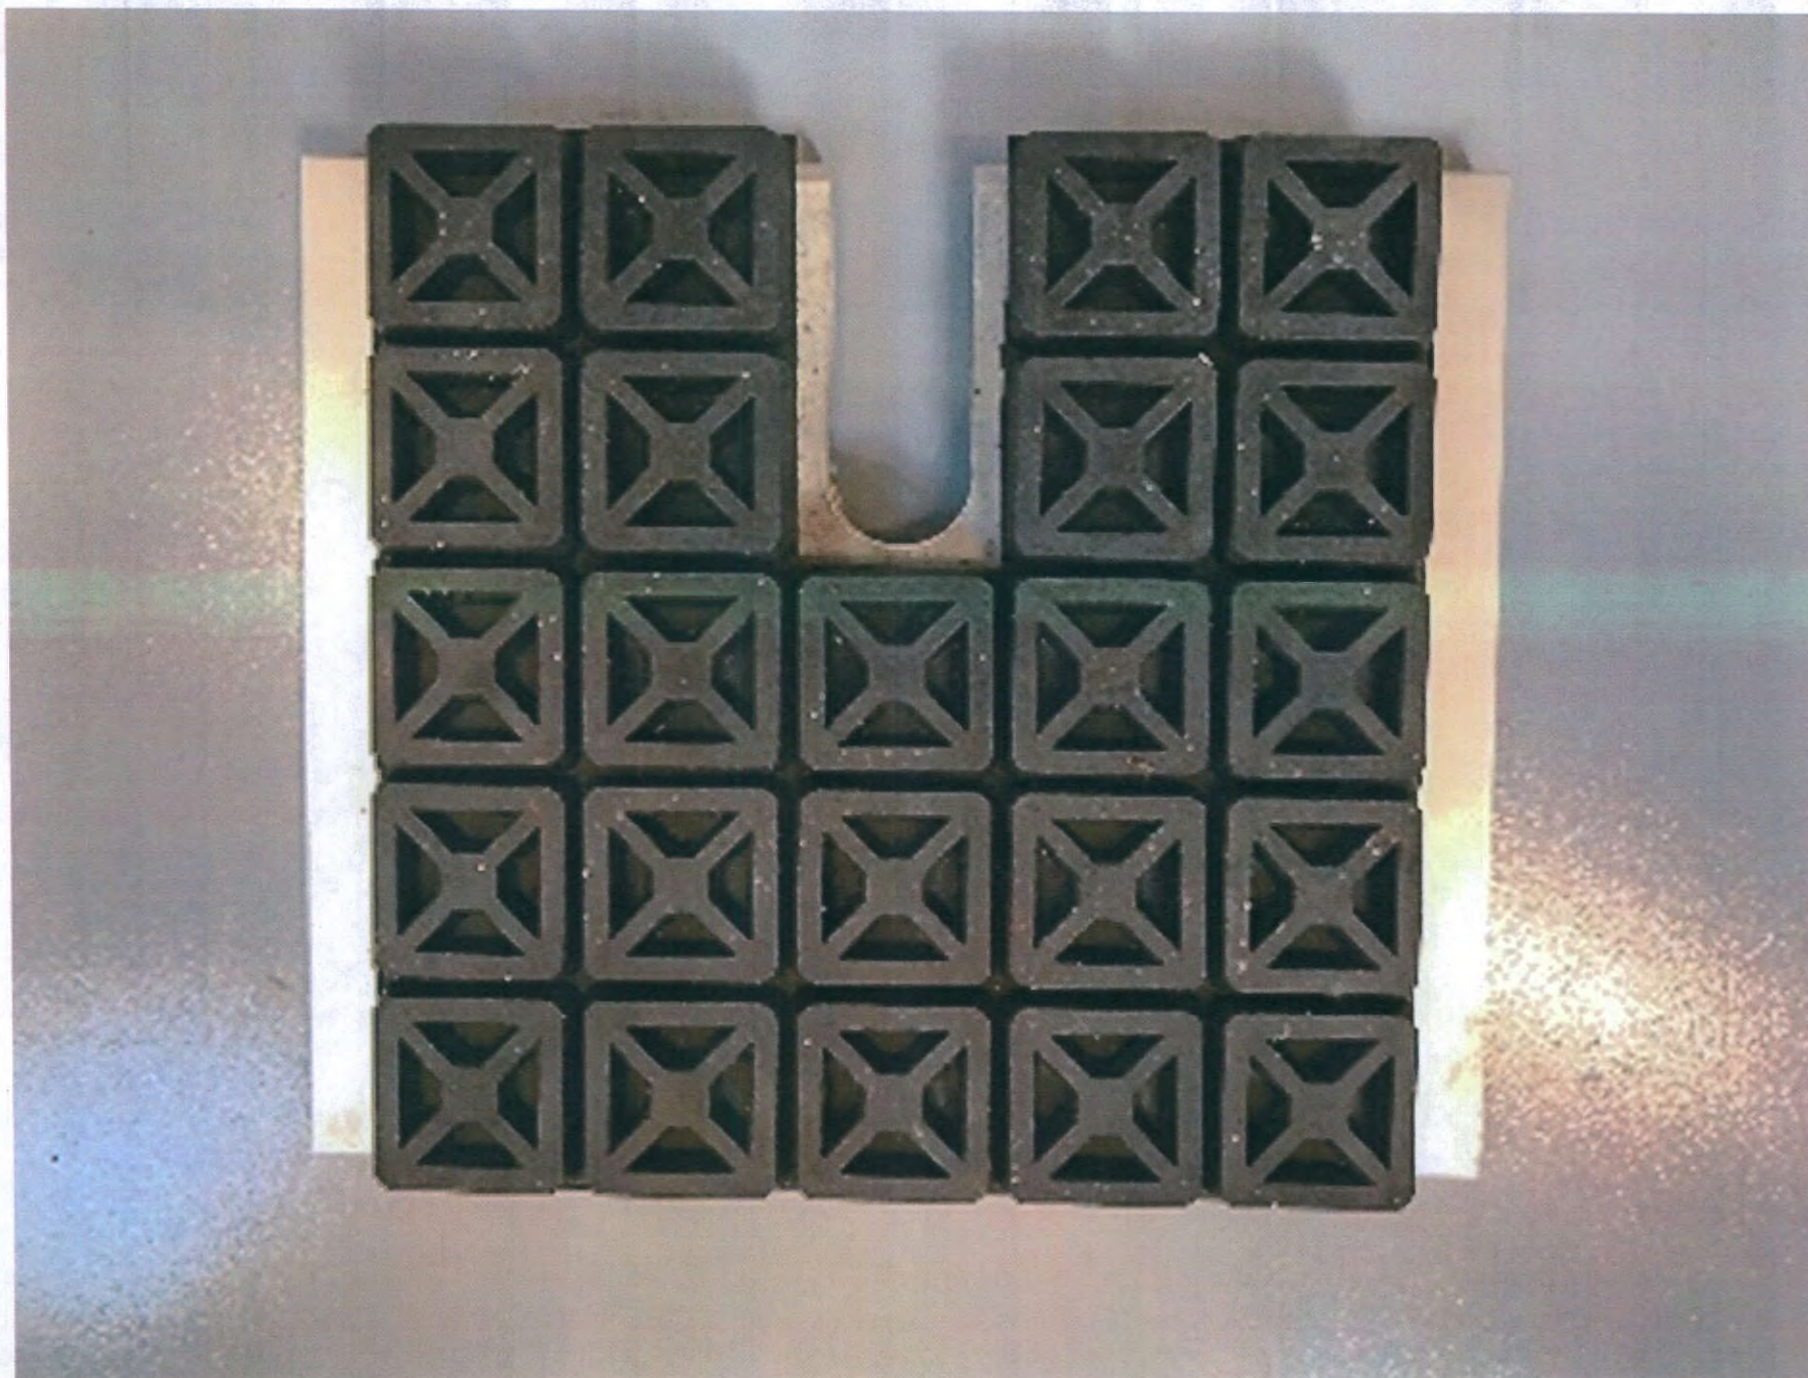







32. Блоки охлаждения МР-томографа (не более 20 шт.).








32. Блоки охлаждения МР-томографа (не более 20 шт.).







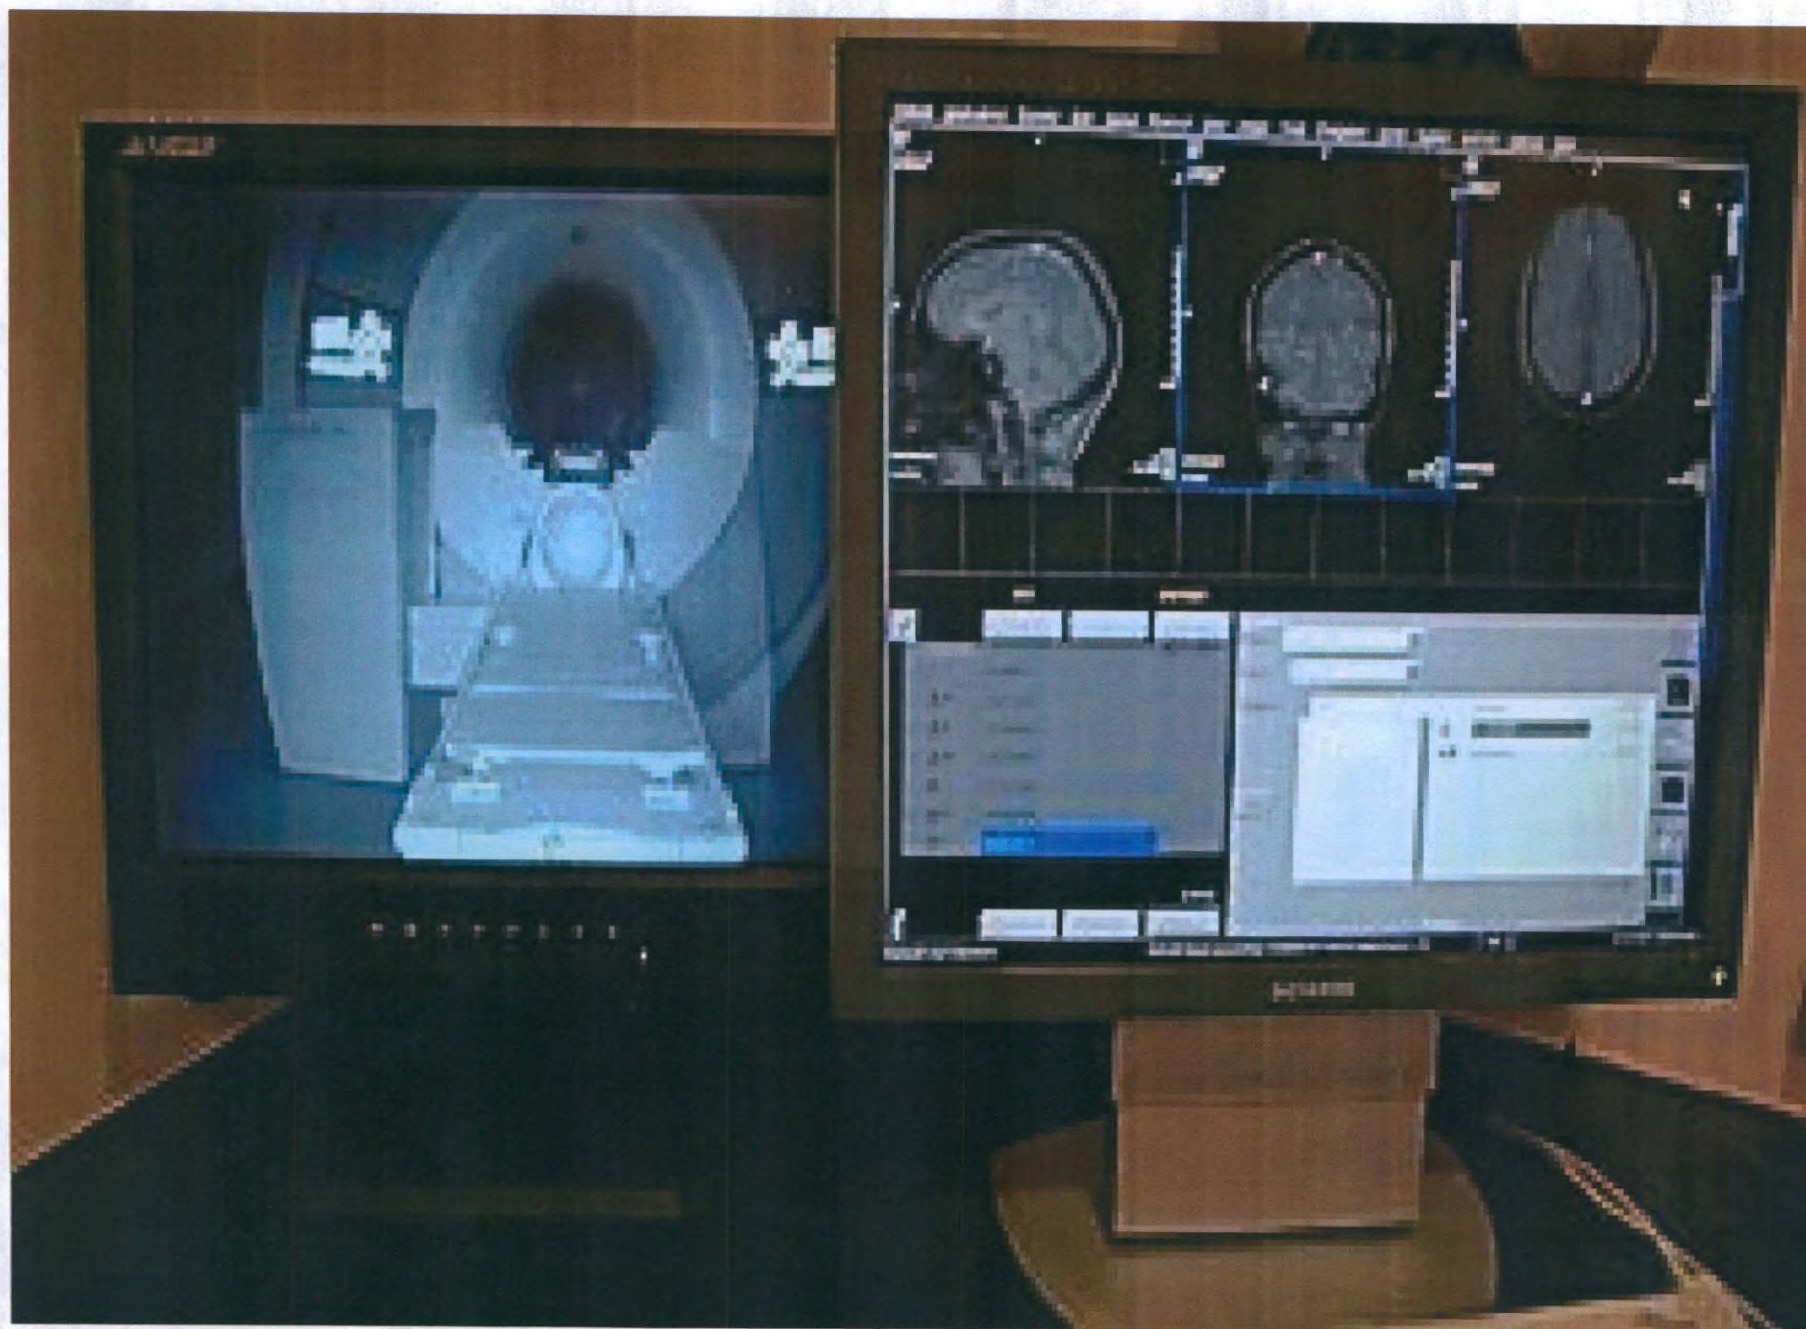







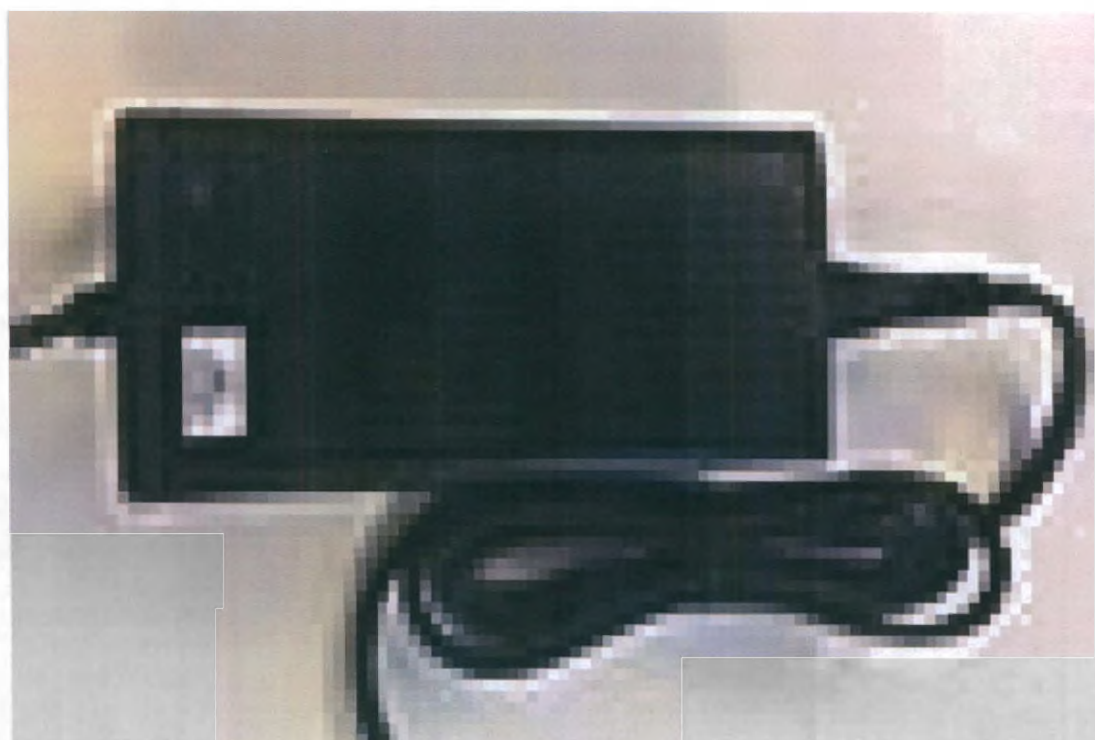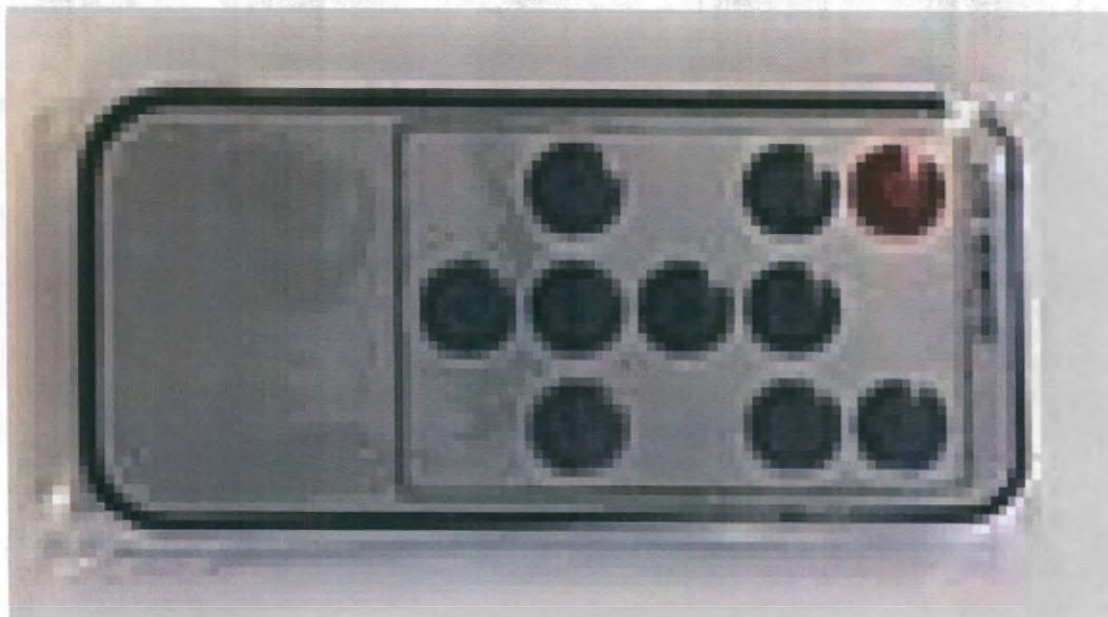





35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).




35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).

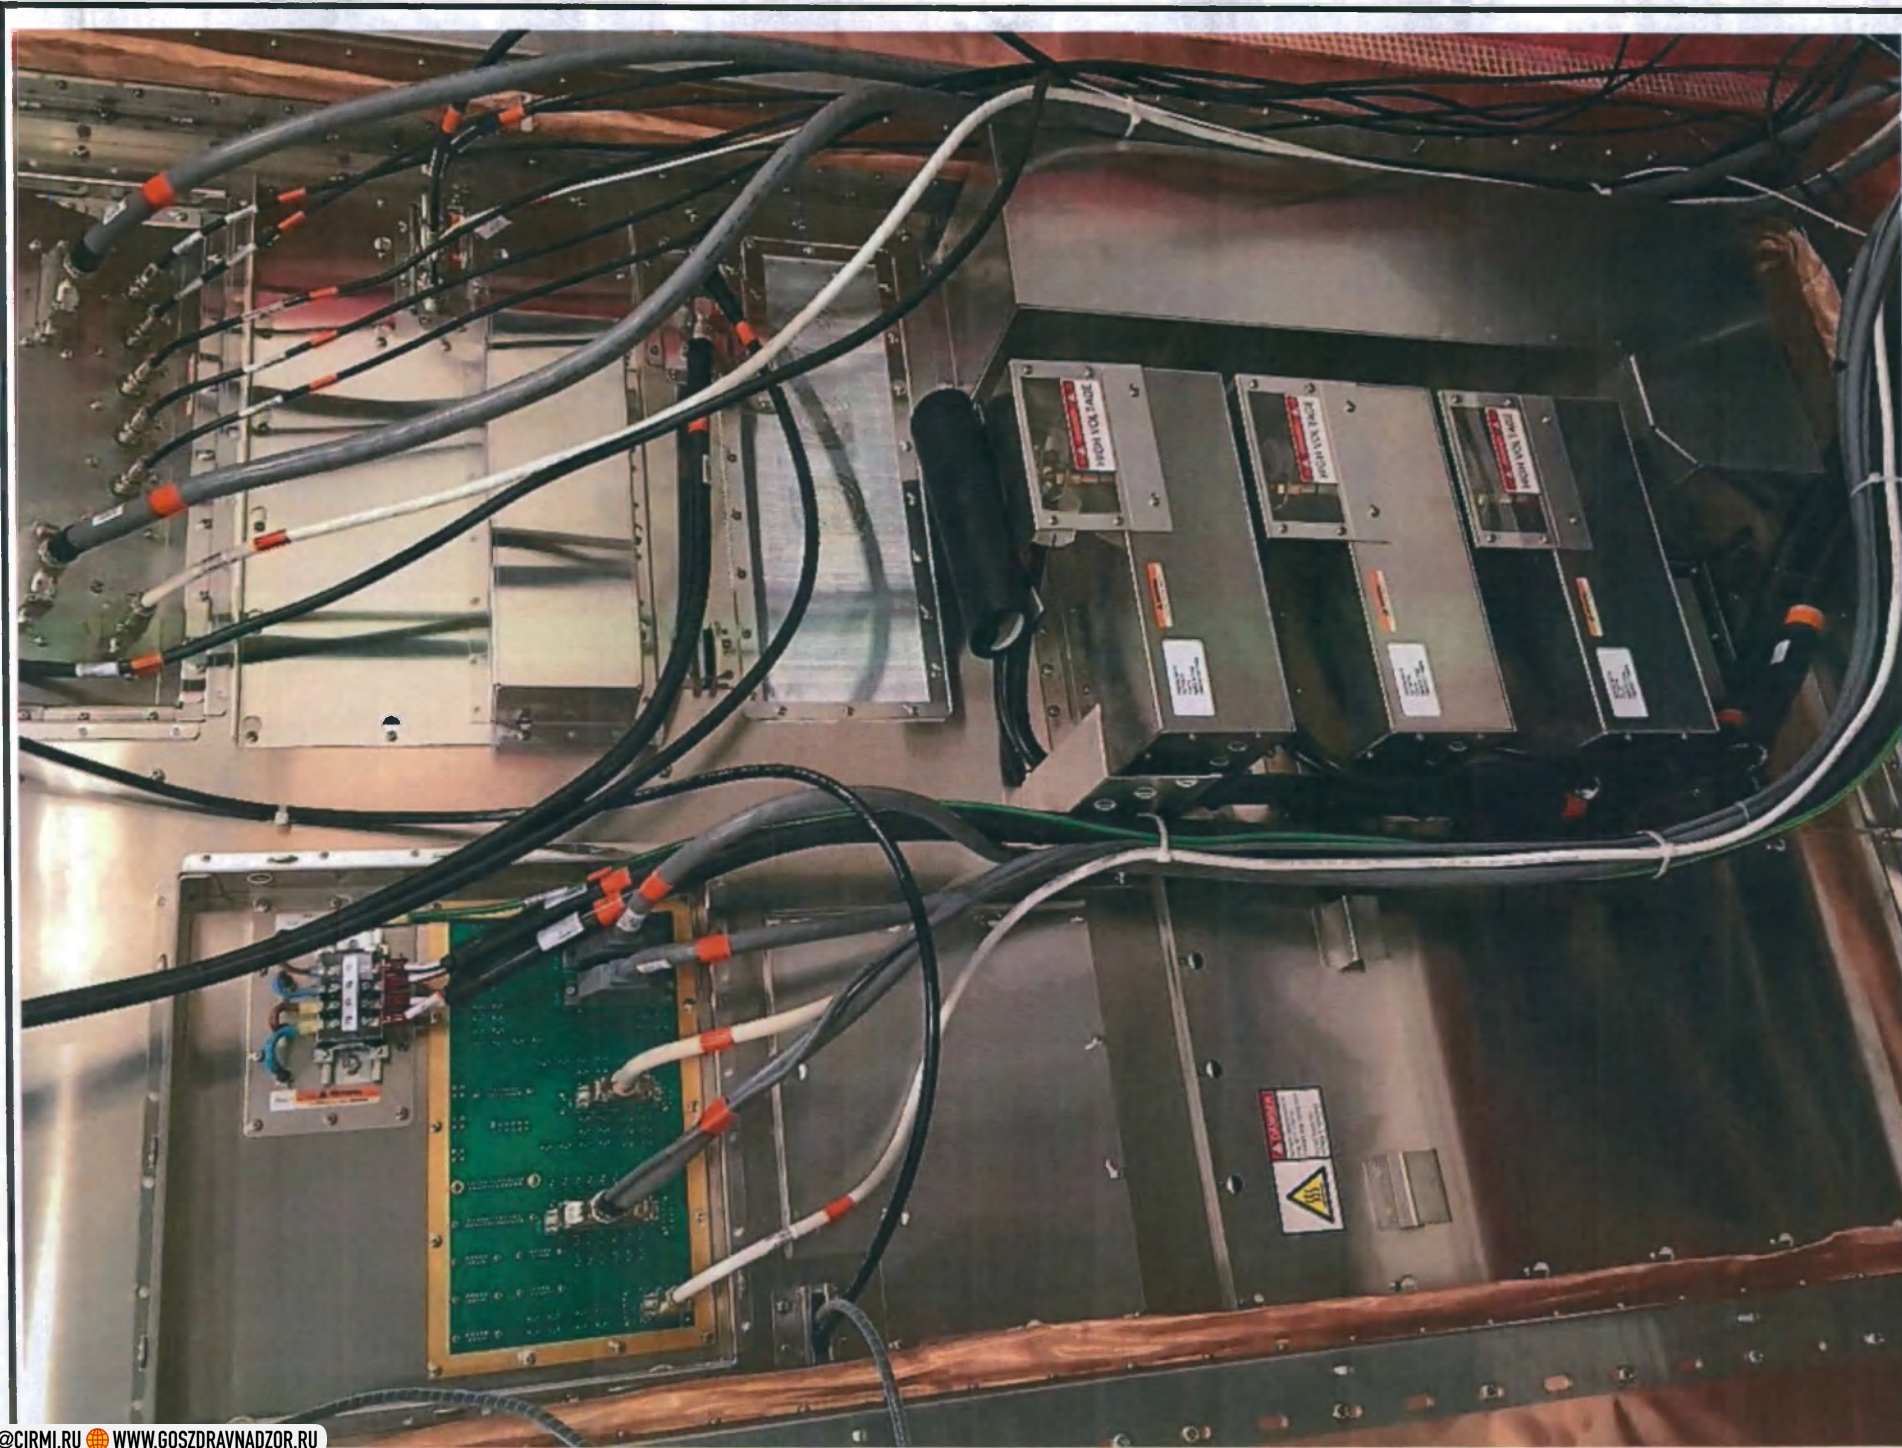

35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).

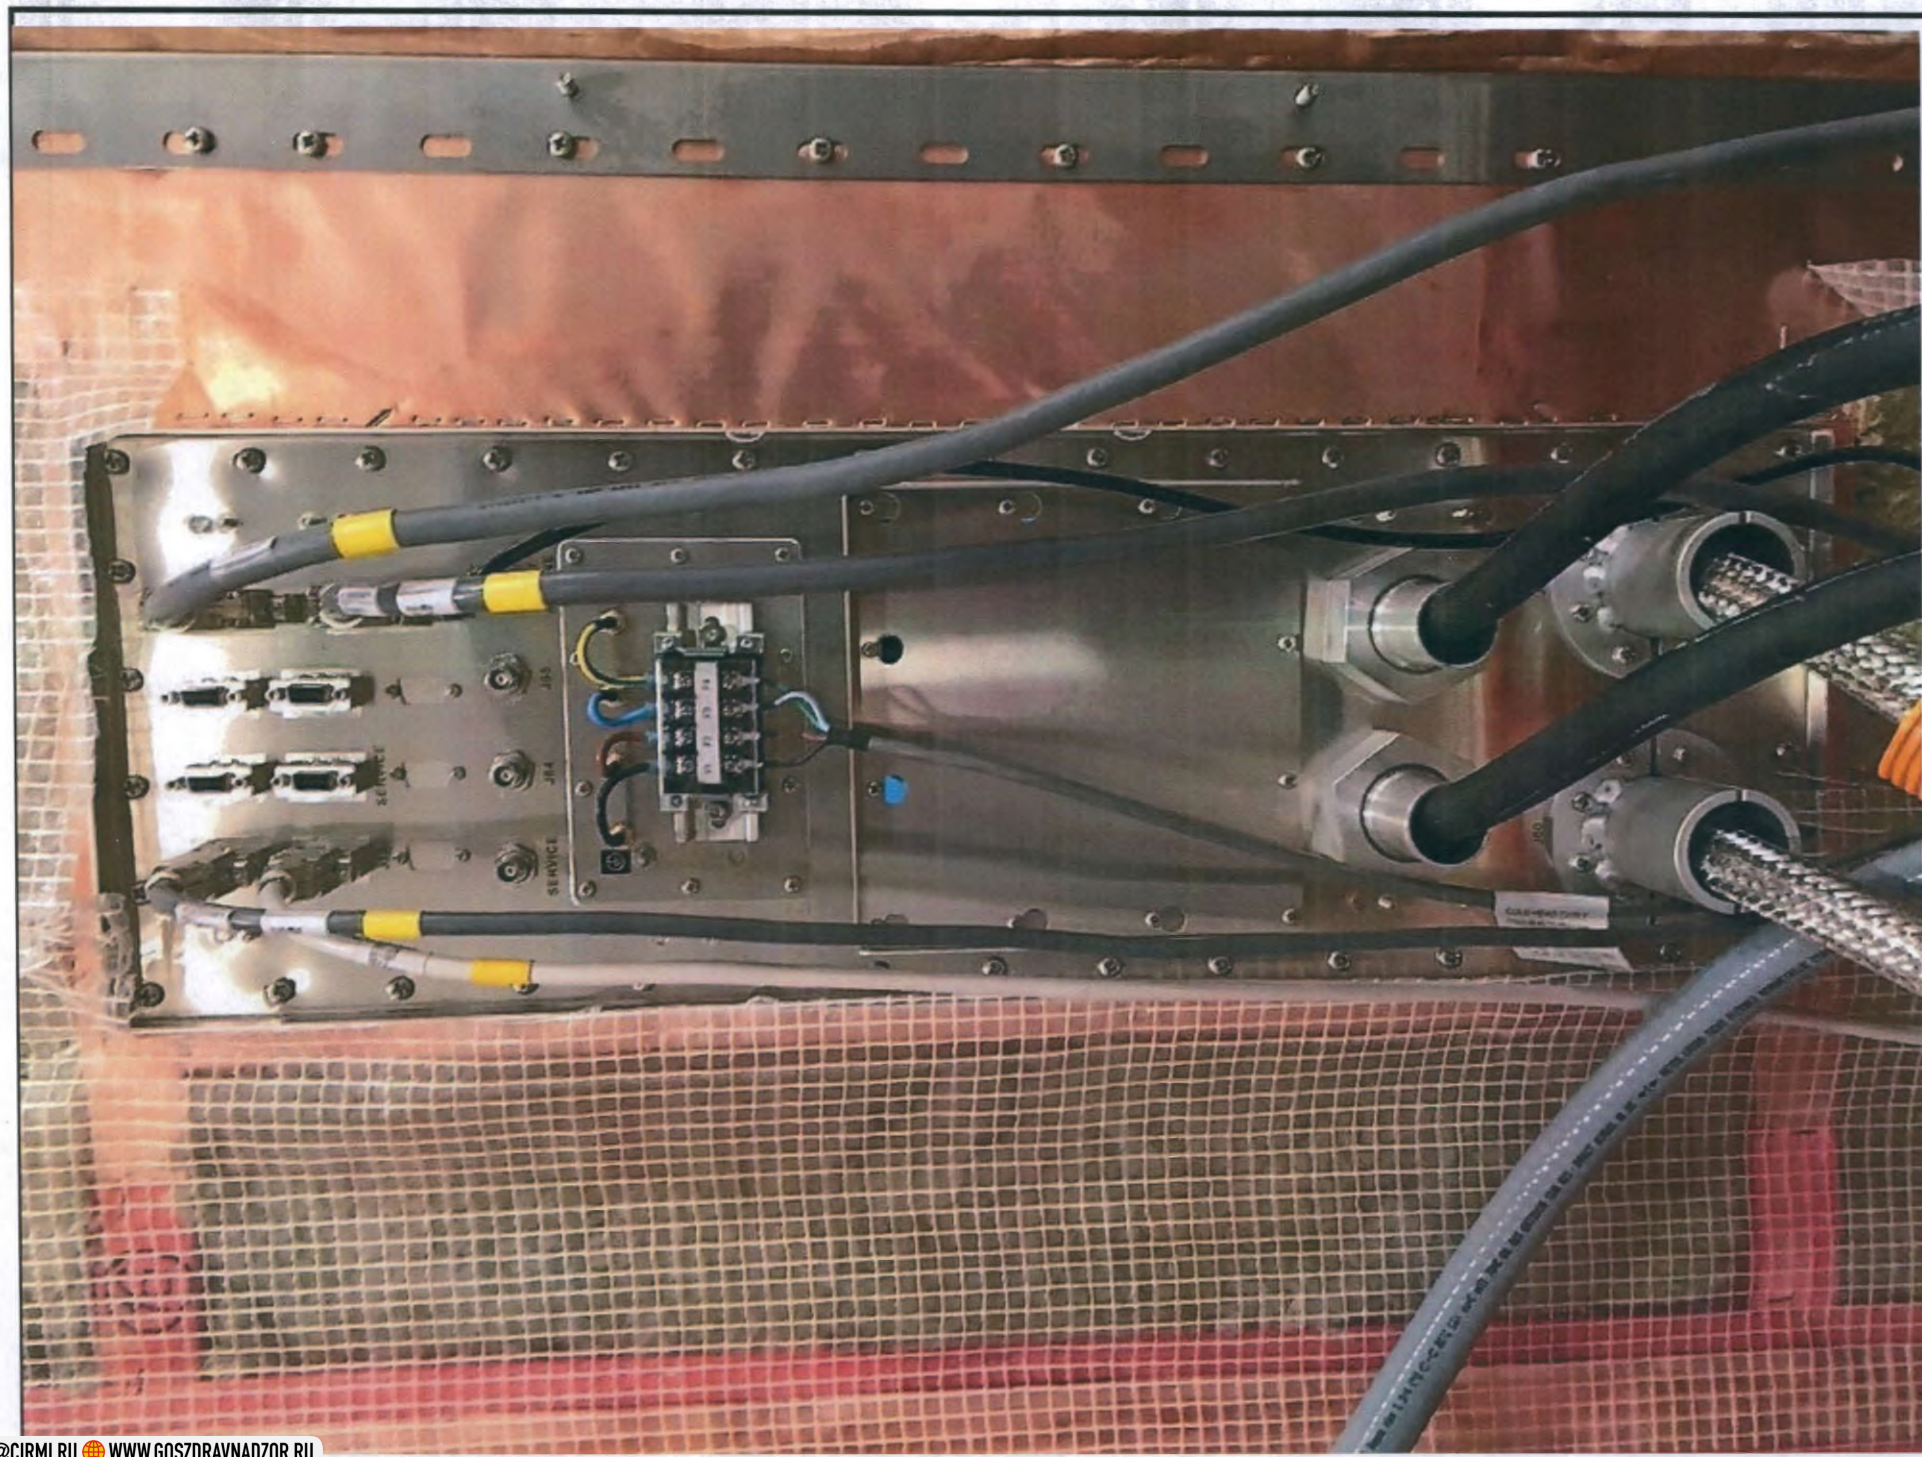

35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).

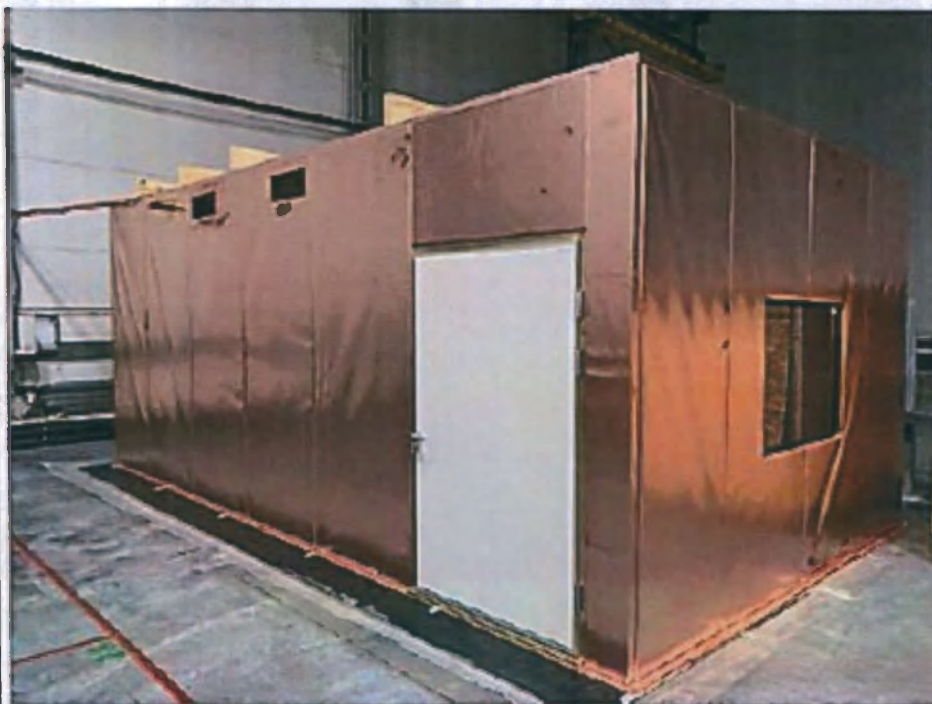

35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



35. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



36. Контейнер для транспортировки магнита.







37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 30 шт.).







37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 30 шт.).

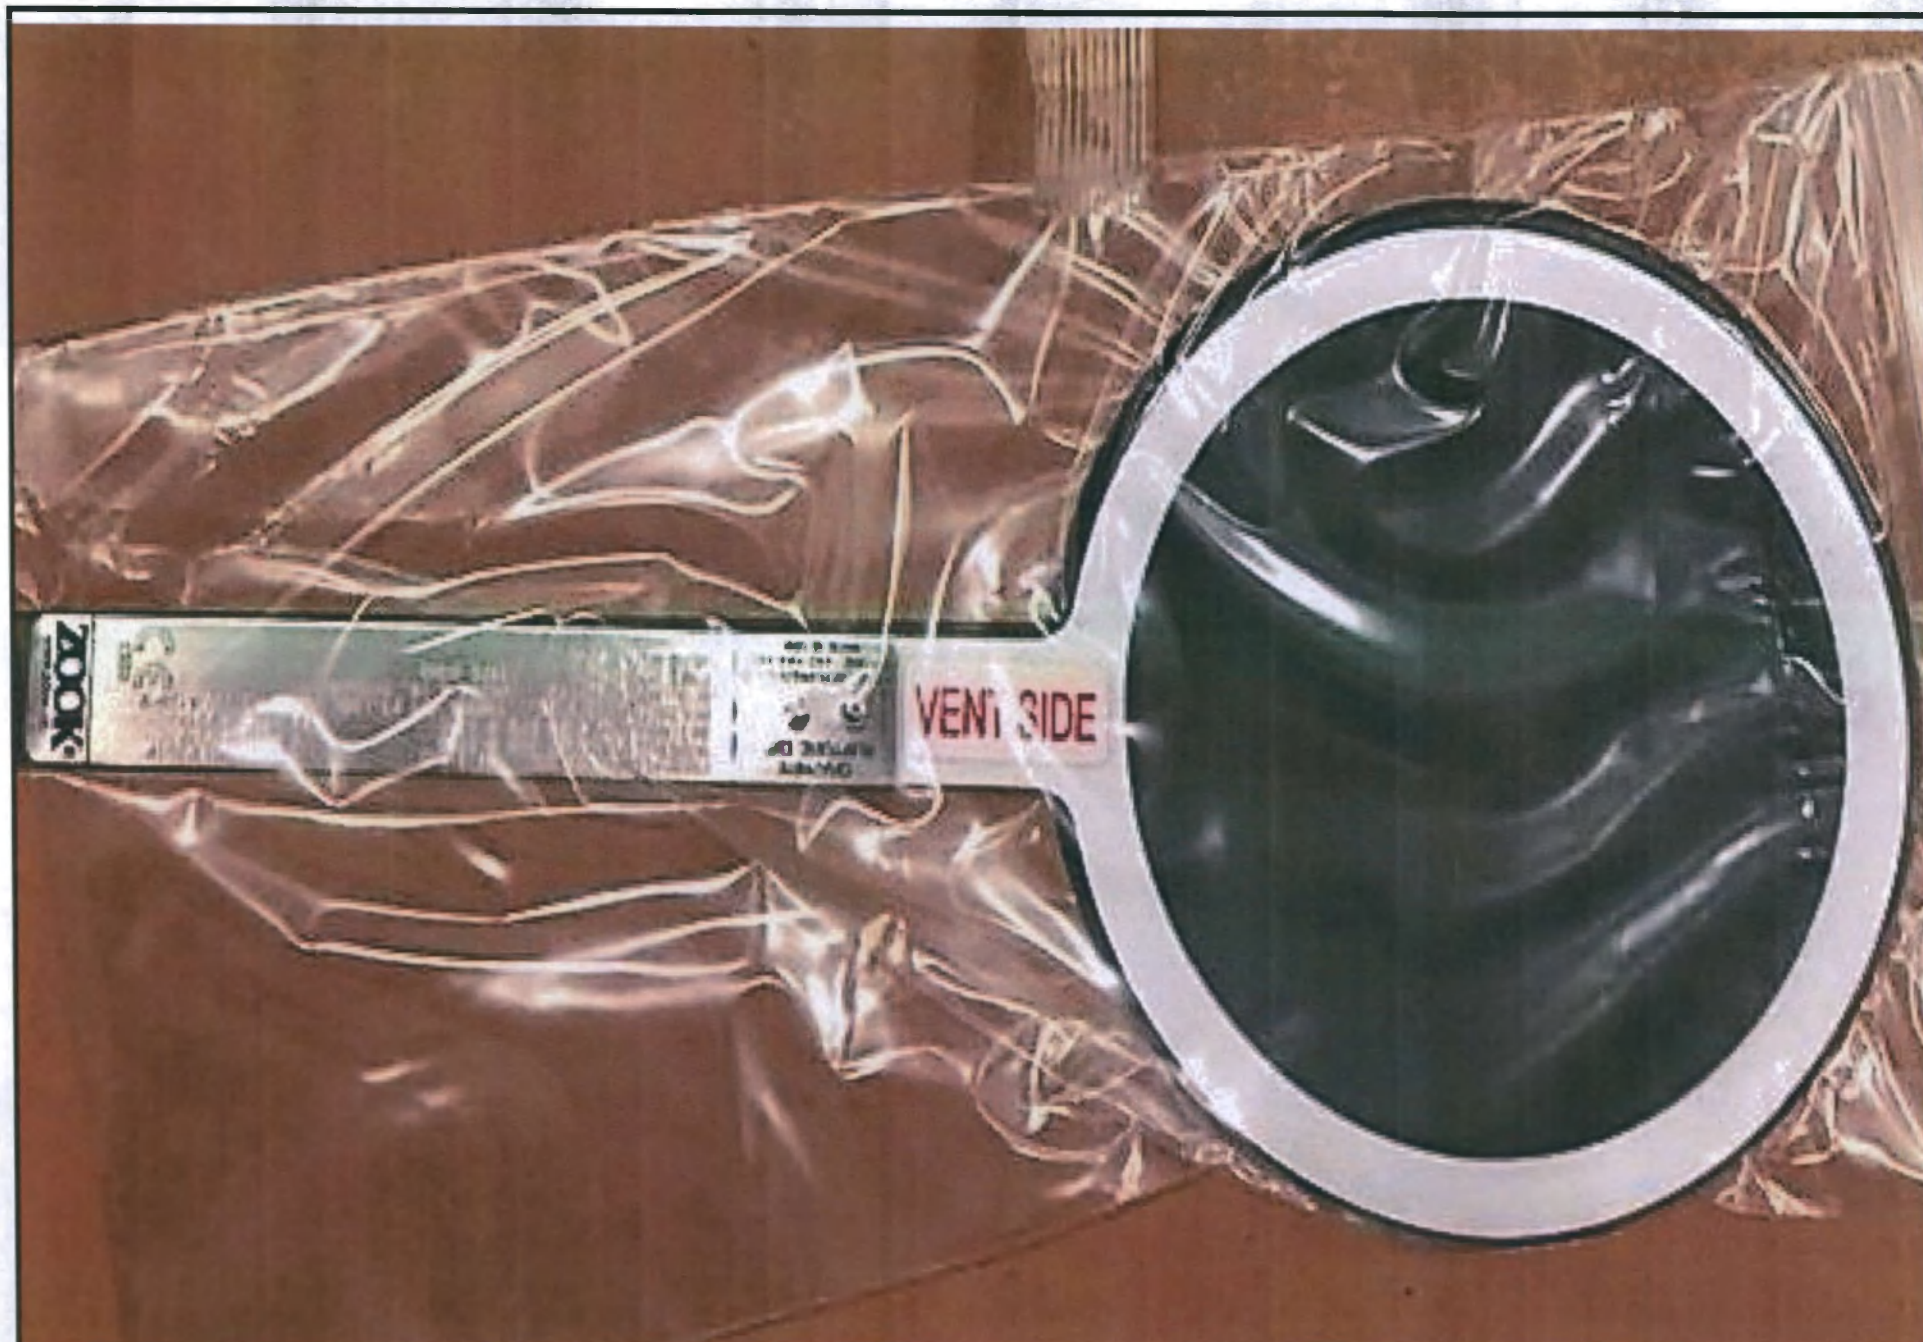

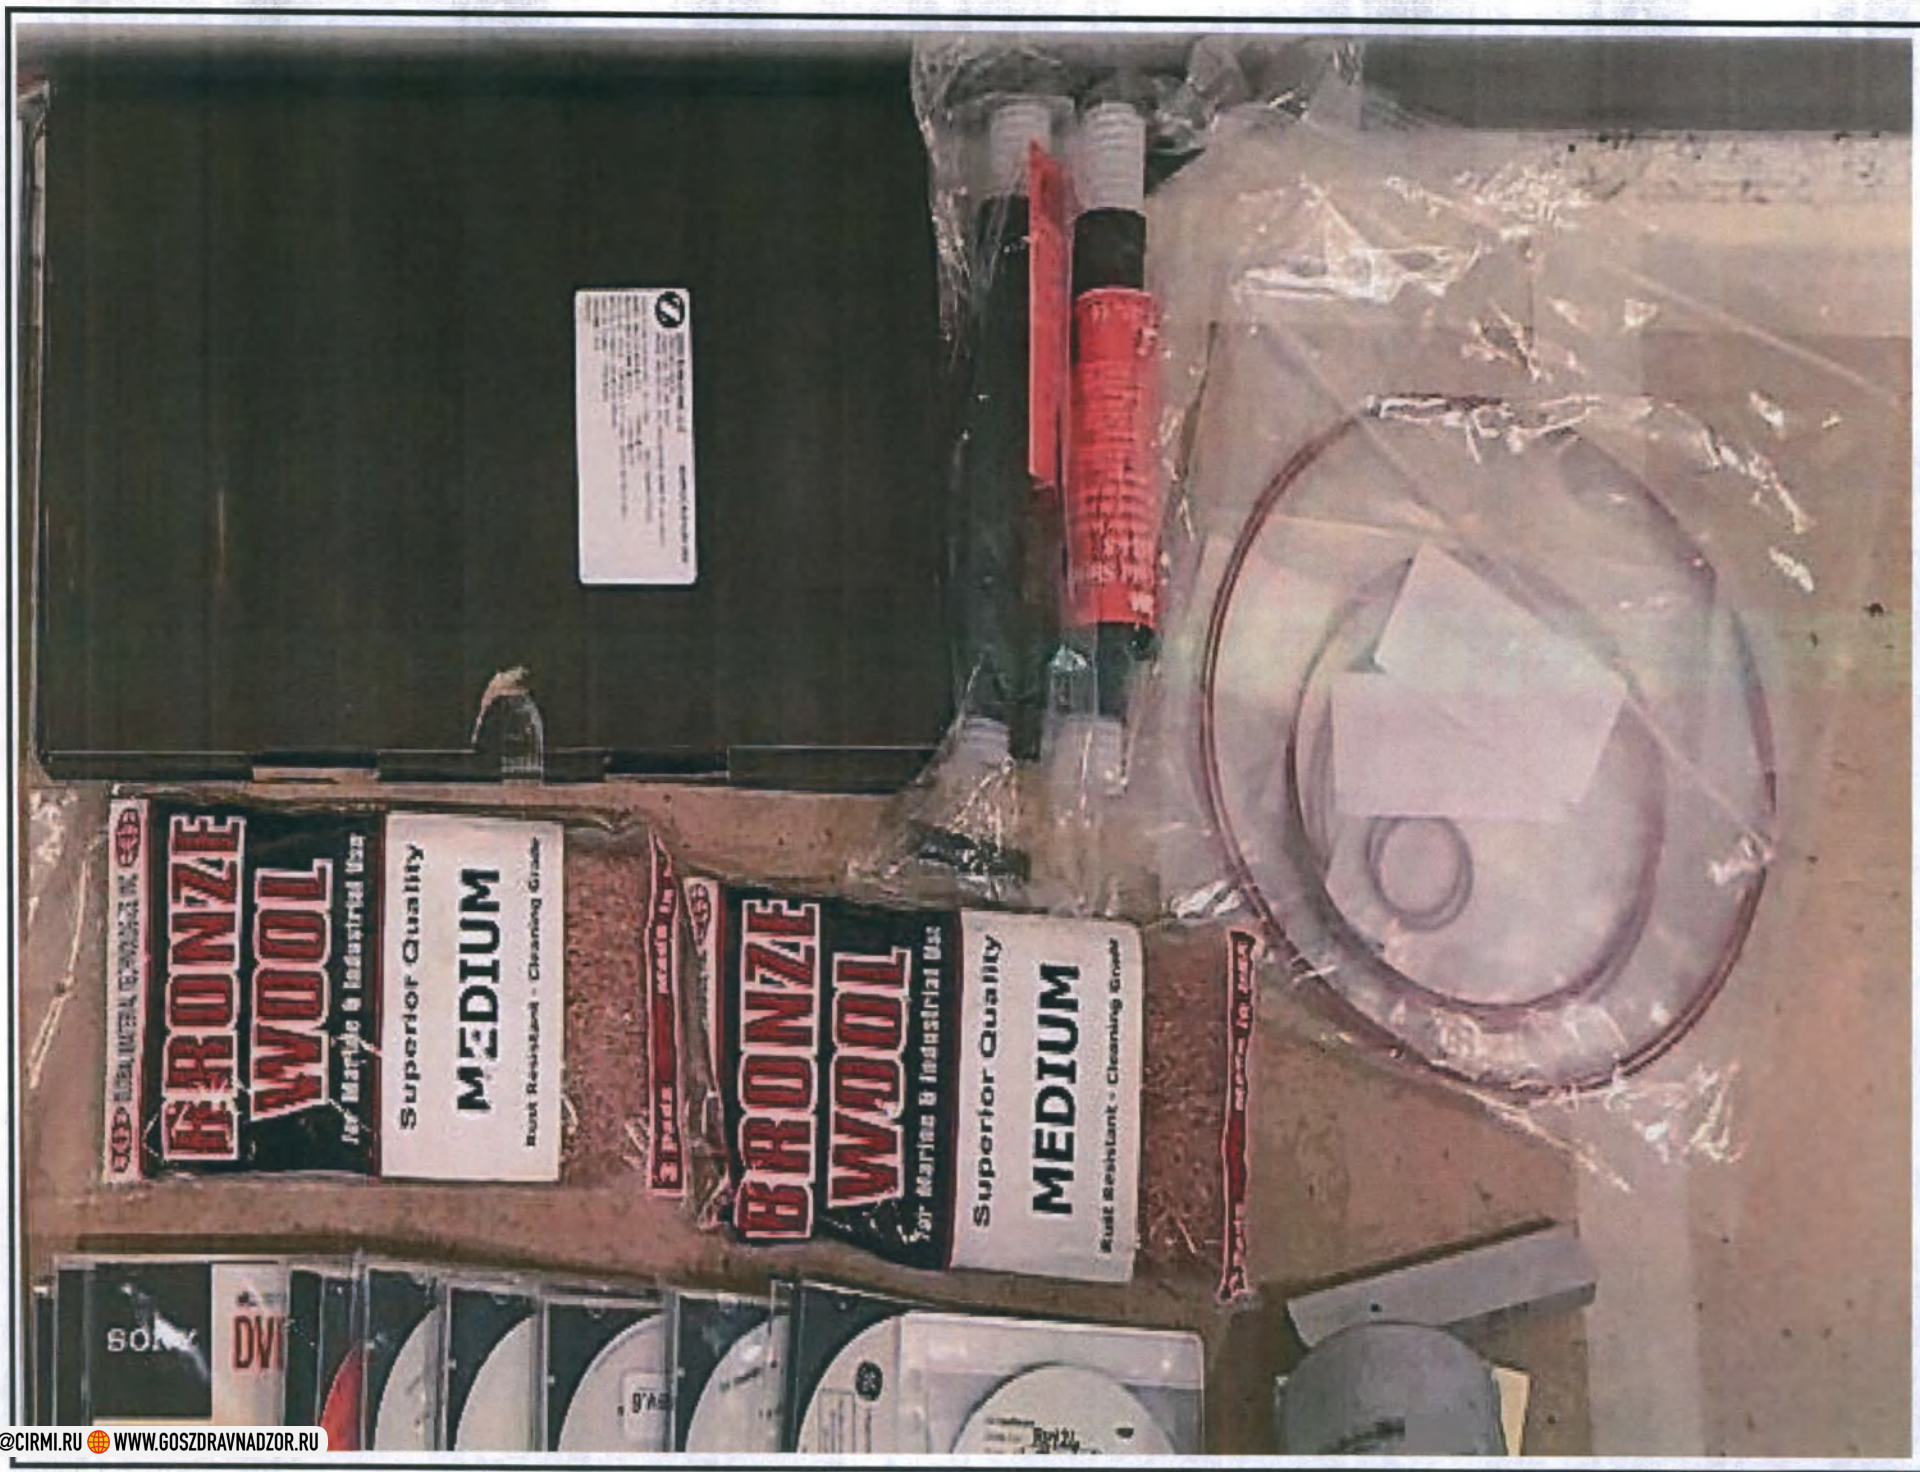

37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 30 шт.).

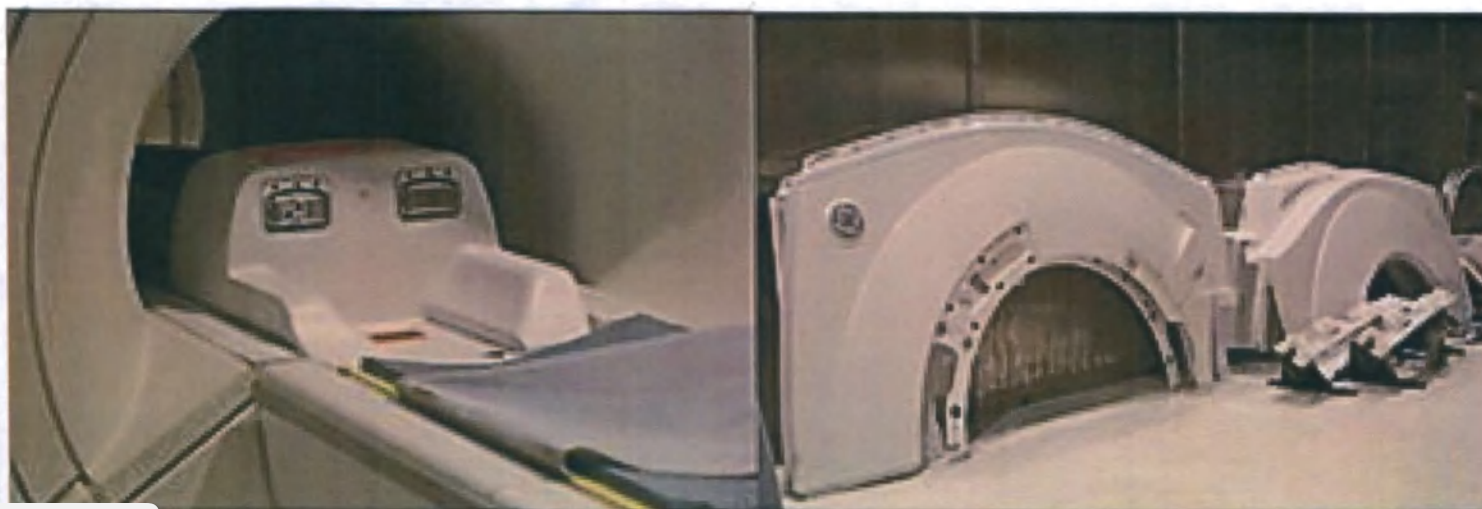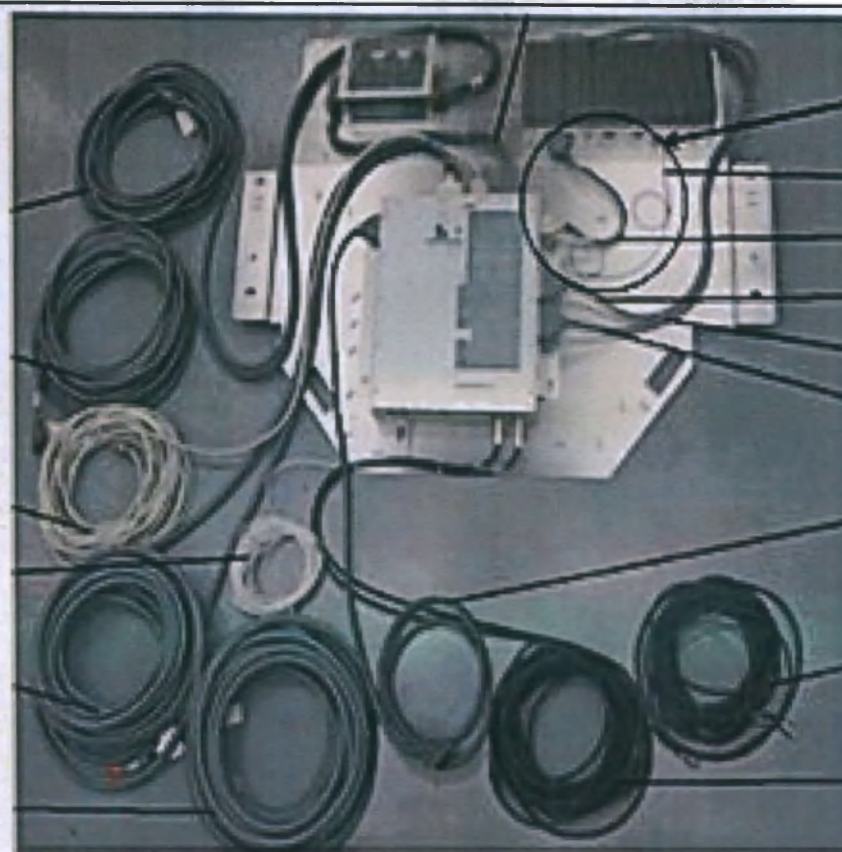








39. Рабочая станция для обработки данных (не более 10 шт.).



39. Рабочая станция для обработки данных (не более 10 шт.).



39. Рабочая станция для обработки данных (не более 10 шт.).

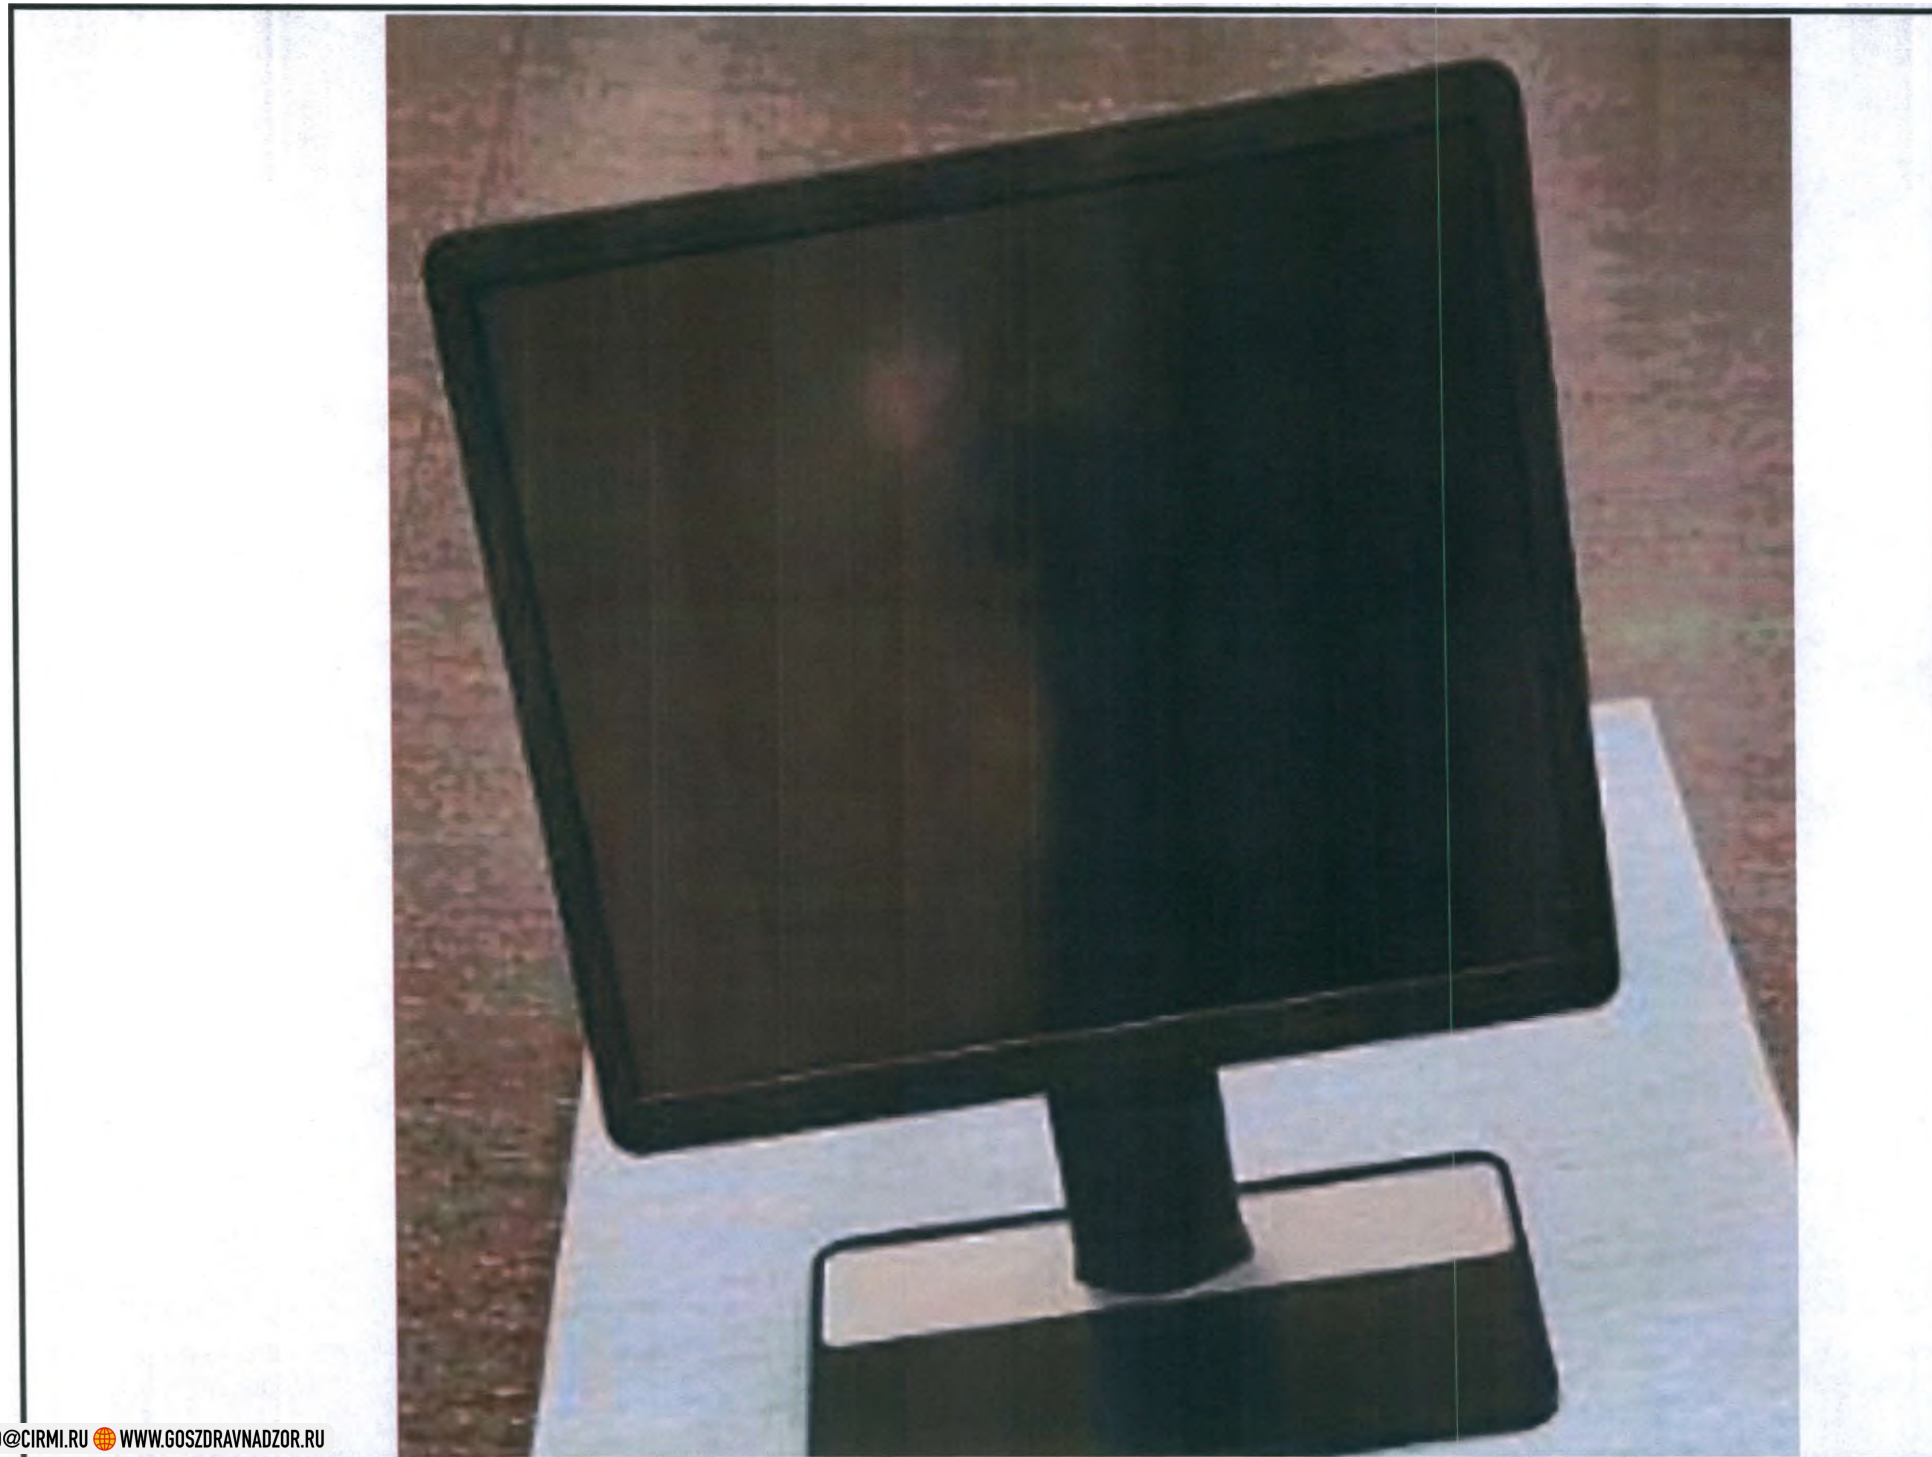


39. Рабочая станция для обработки данных (не более 10 шт.).







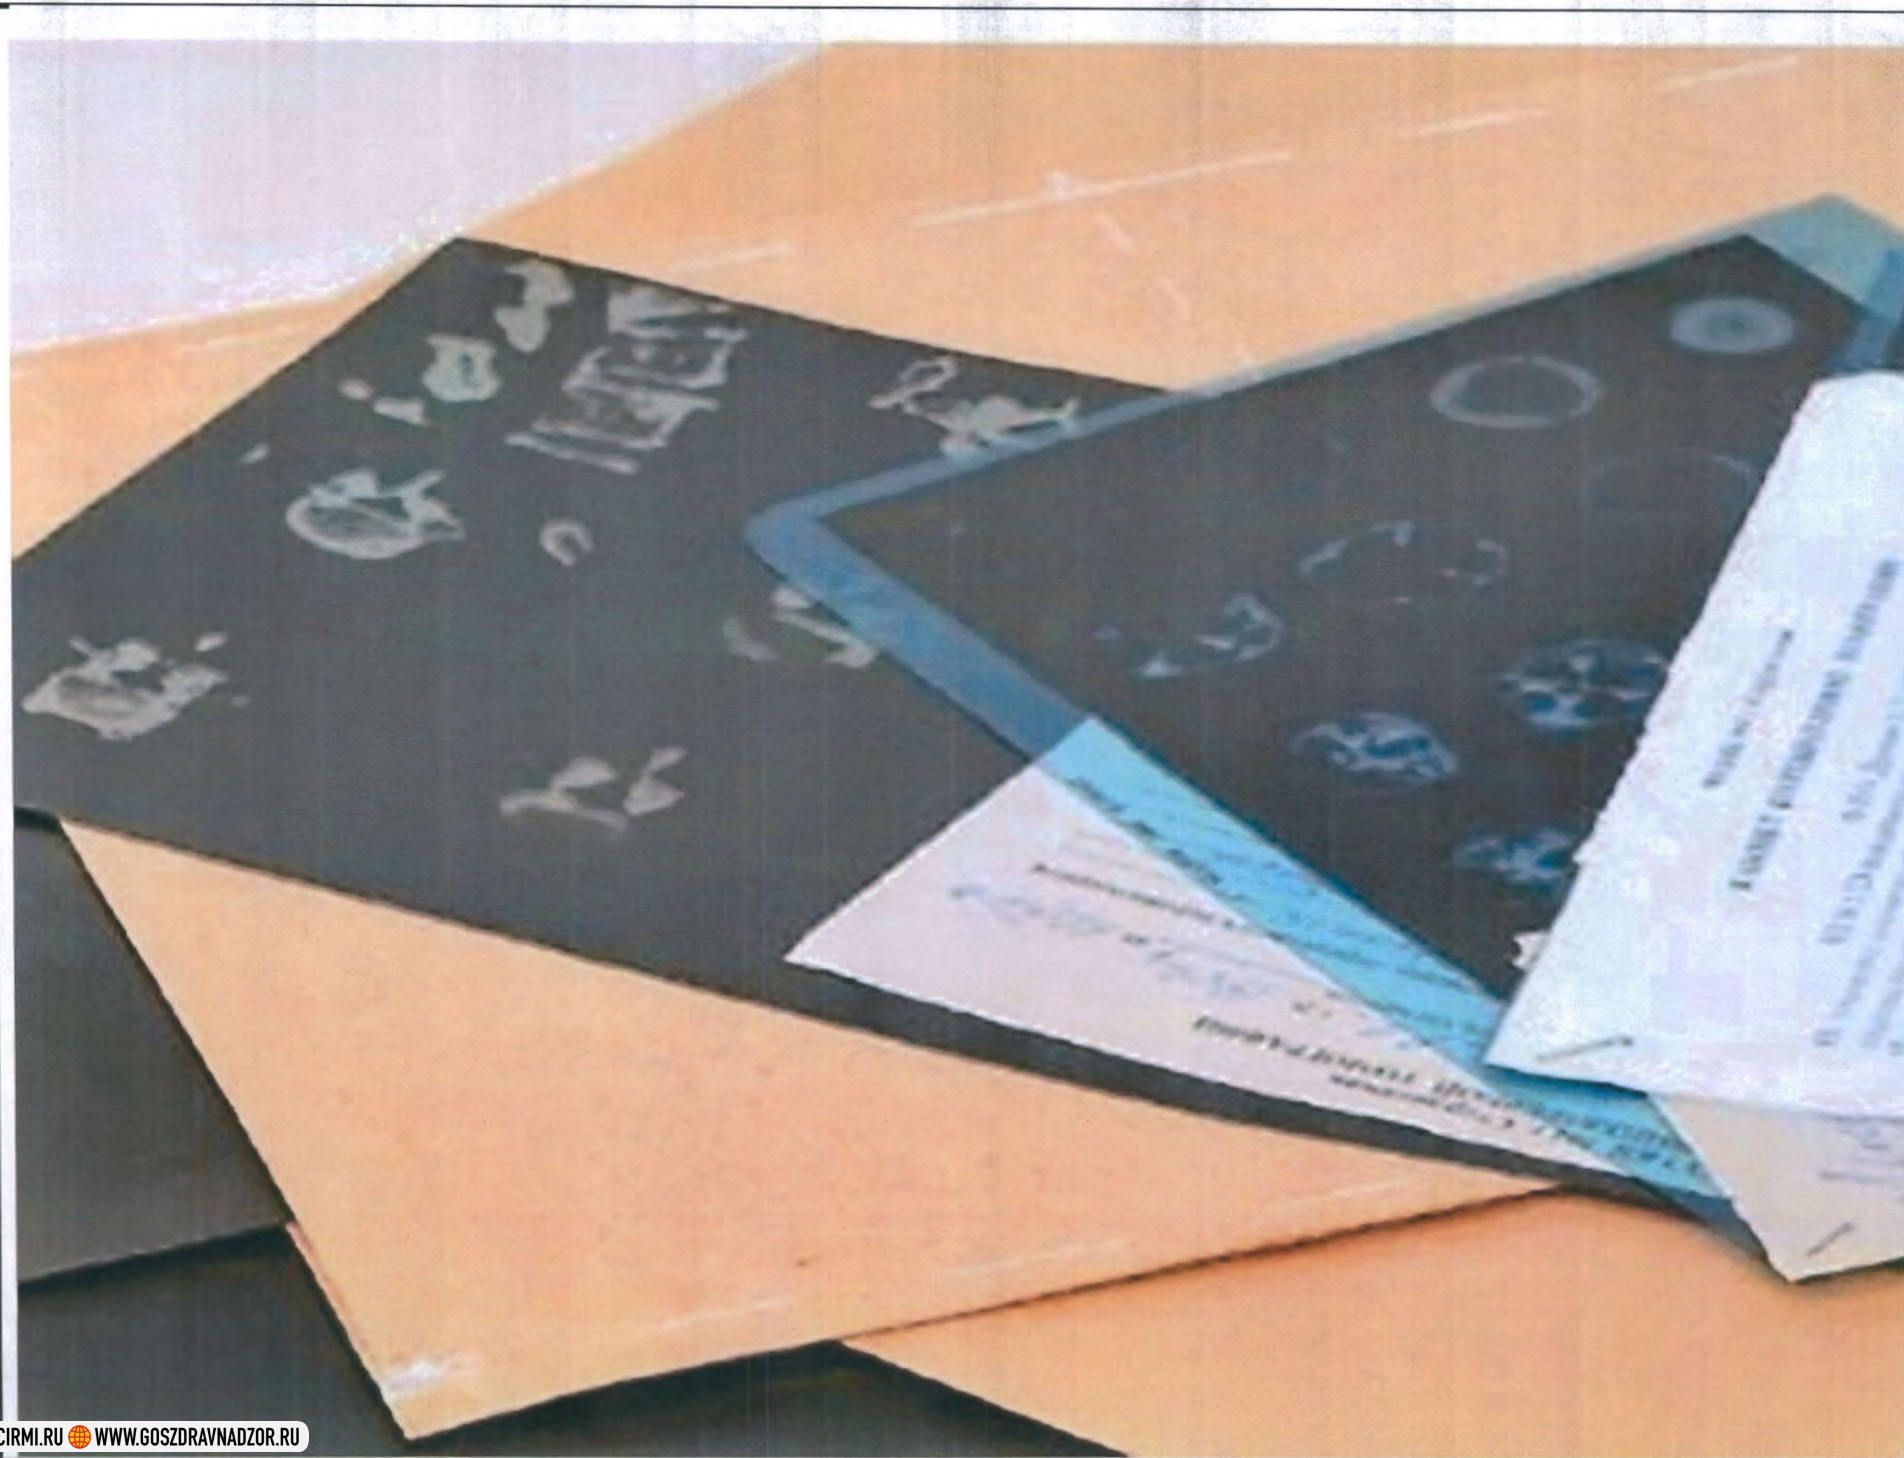









42. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).

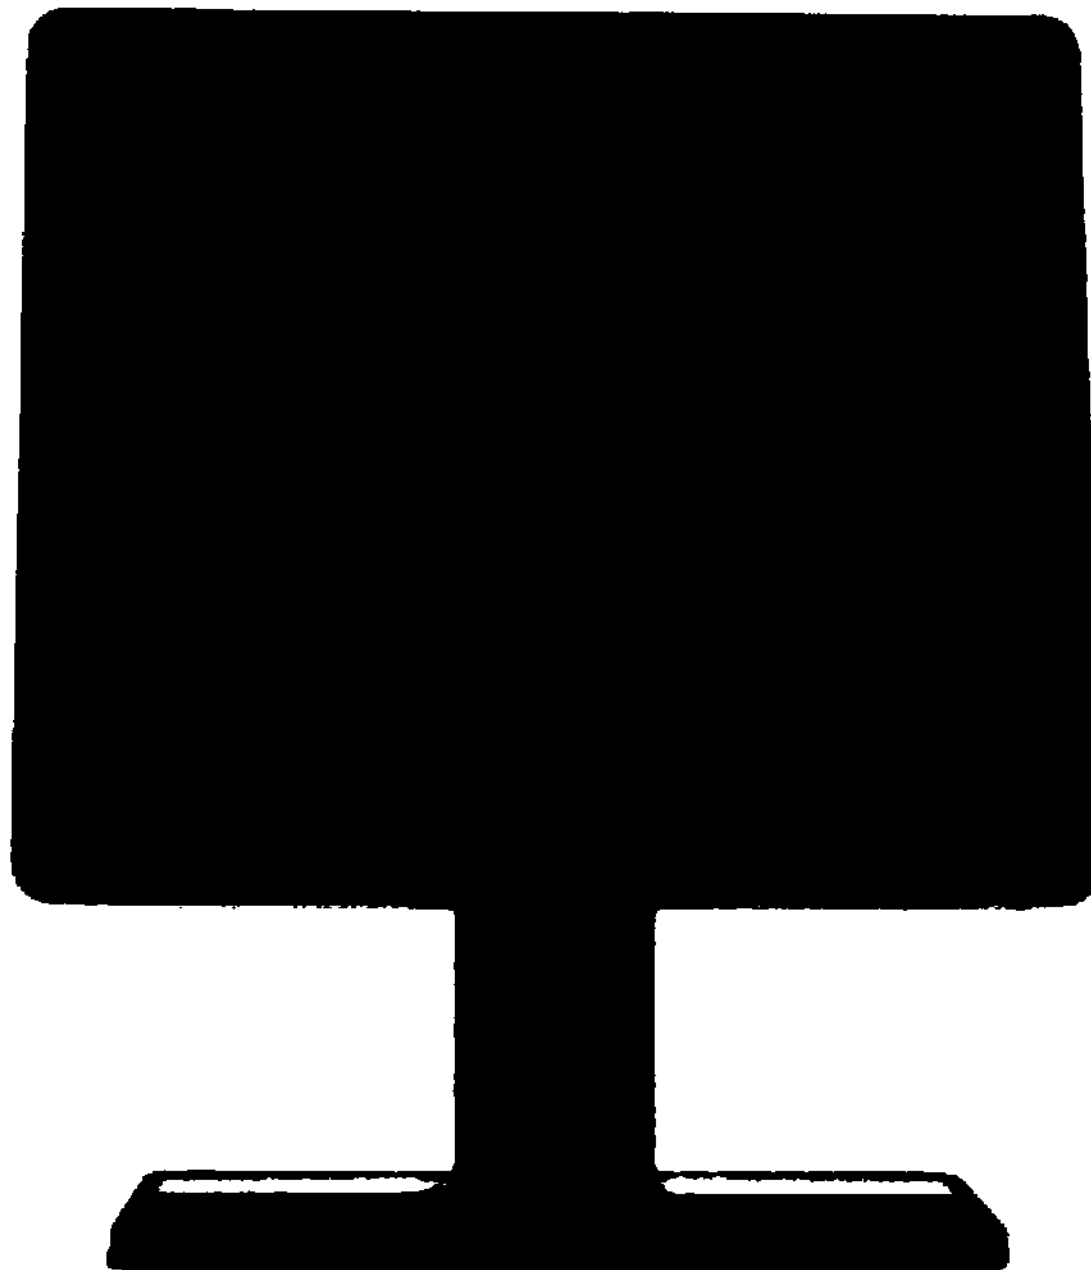

42. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).

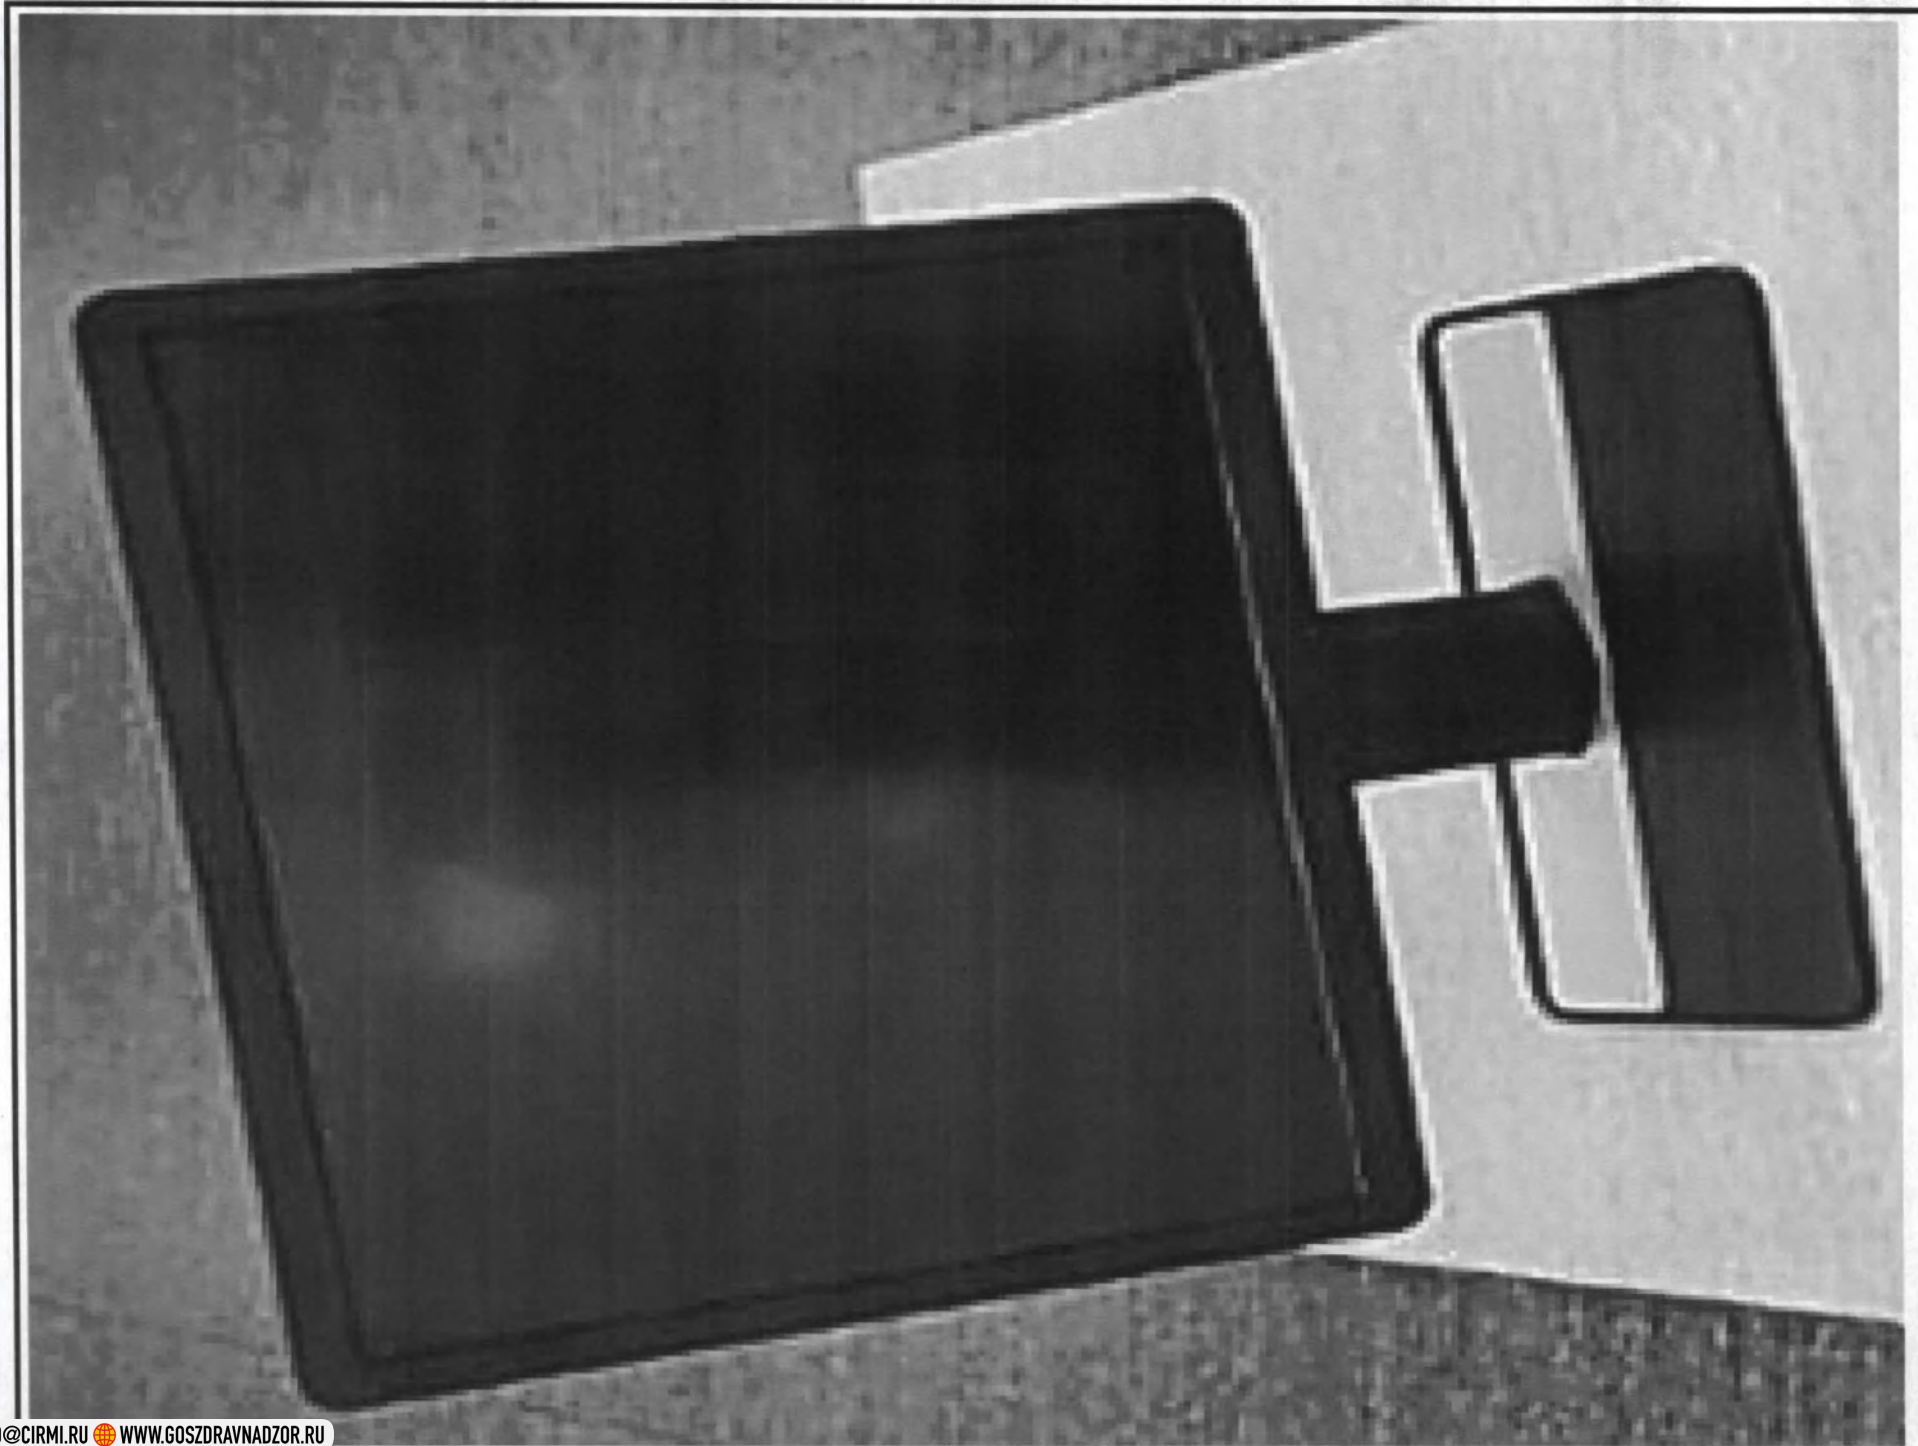

42. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



42. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).












44. Устройство для неинвазивной оценки плотностей тканей.








46. Вспомогательное оборудование для обработки результатов исследований (не более 5 шт.).

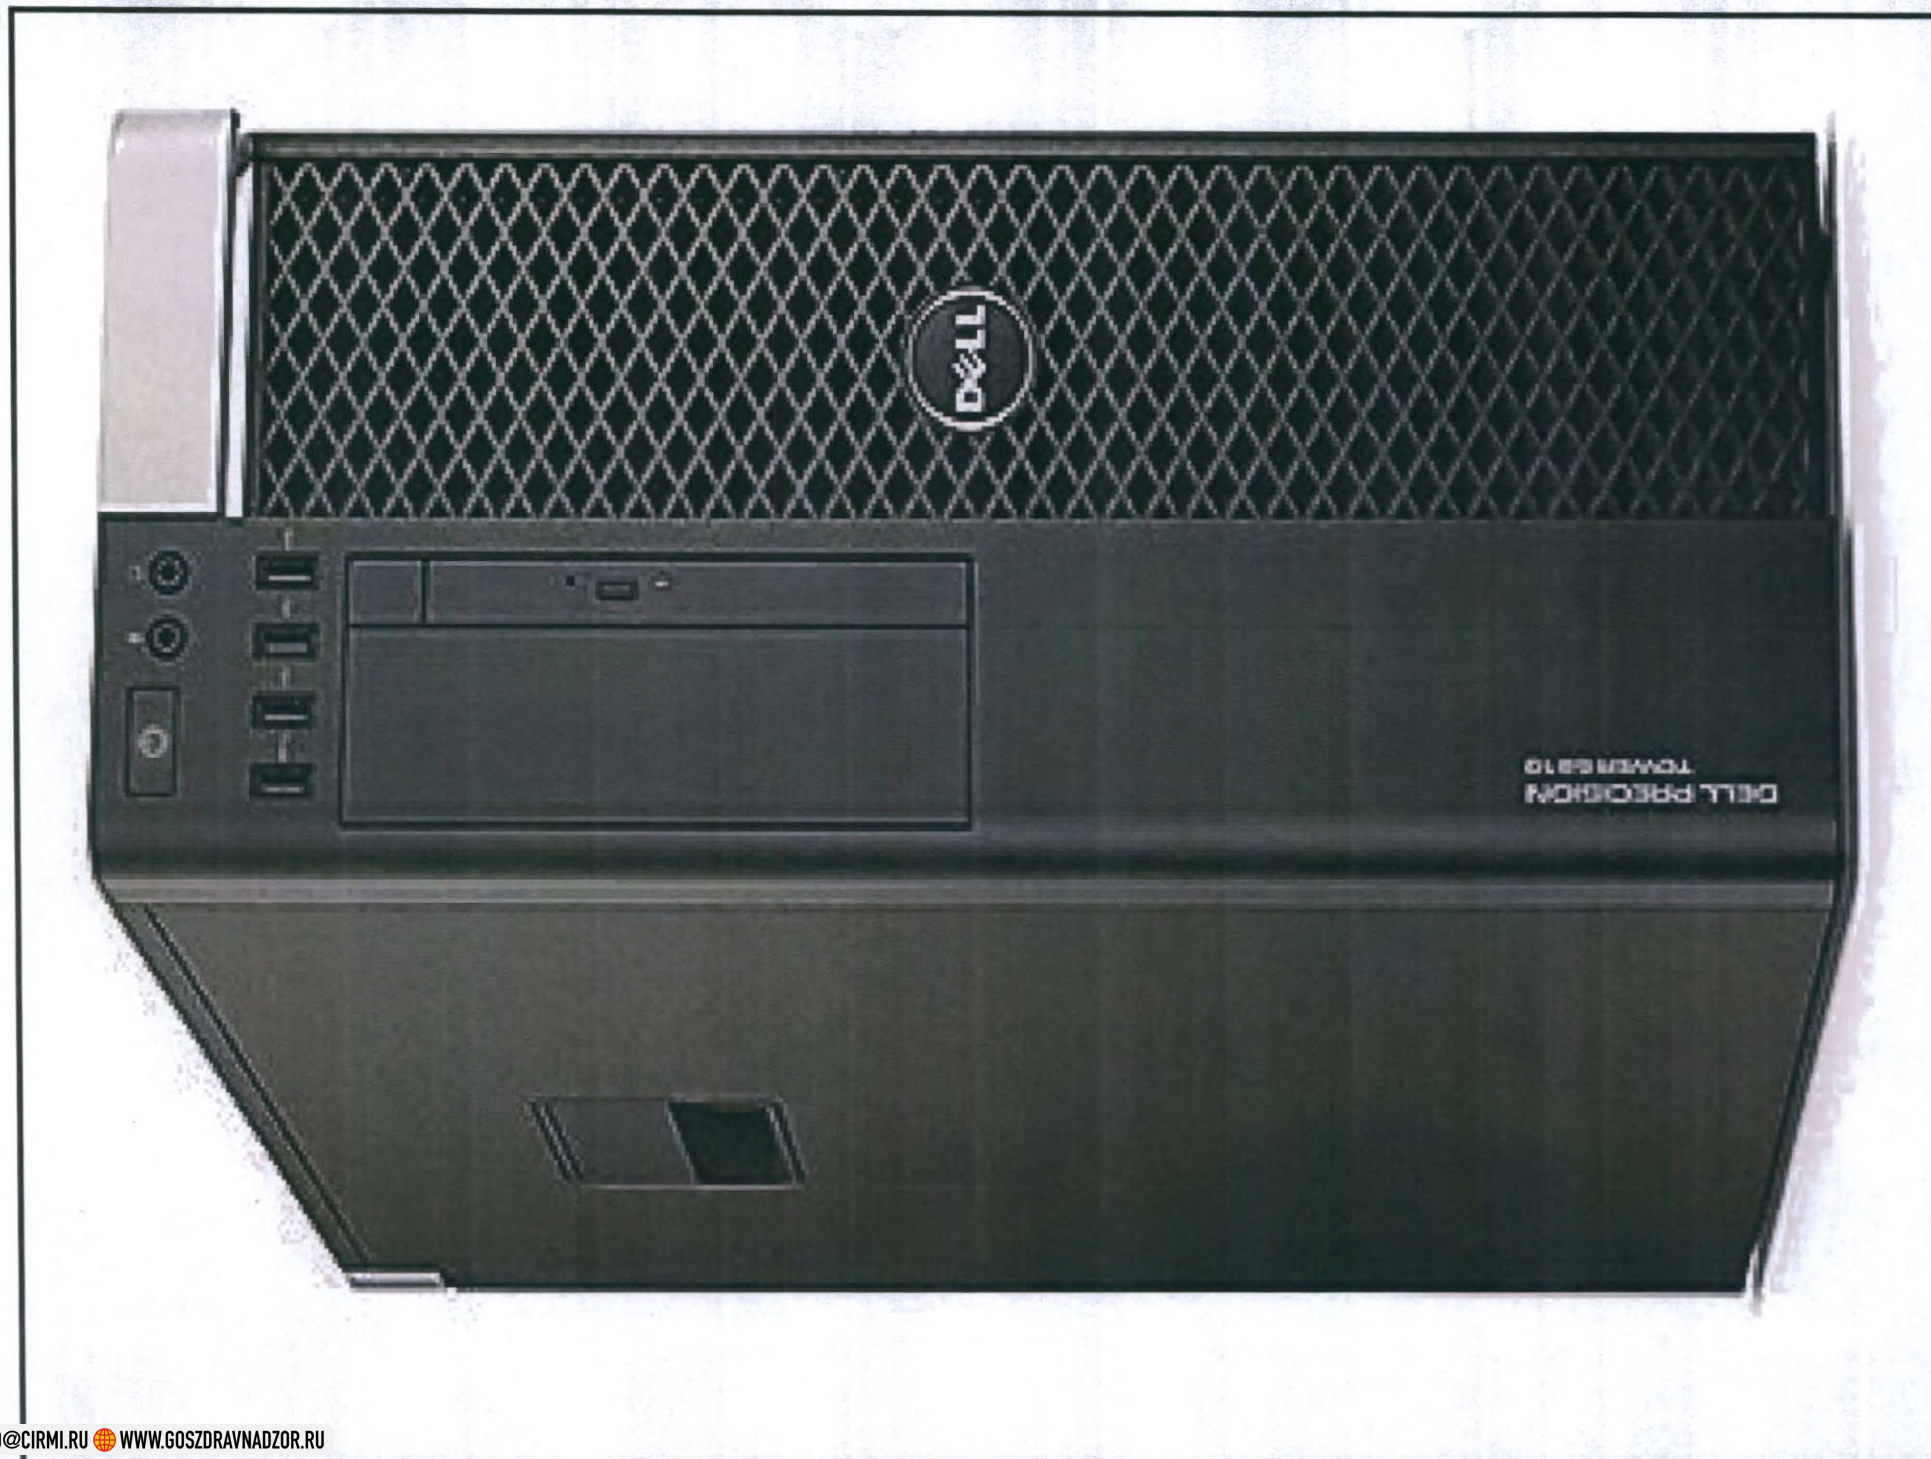


46. Вспомогательное оборудование для обработки результатов исследований (не более 5 шт.).

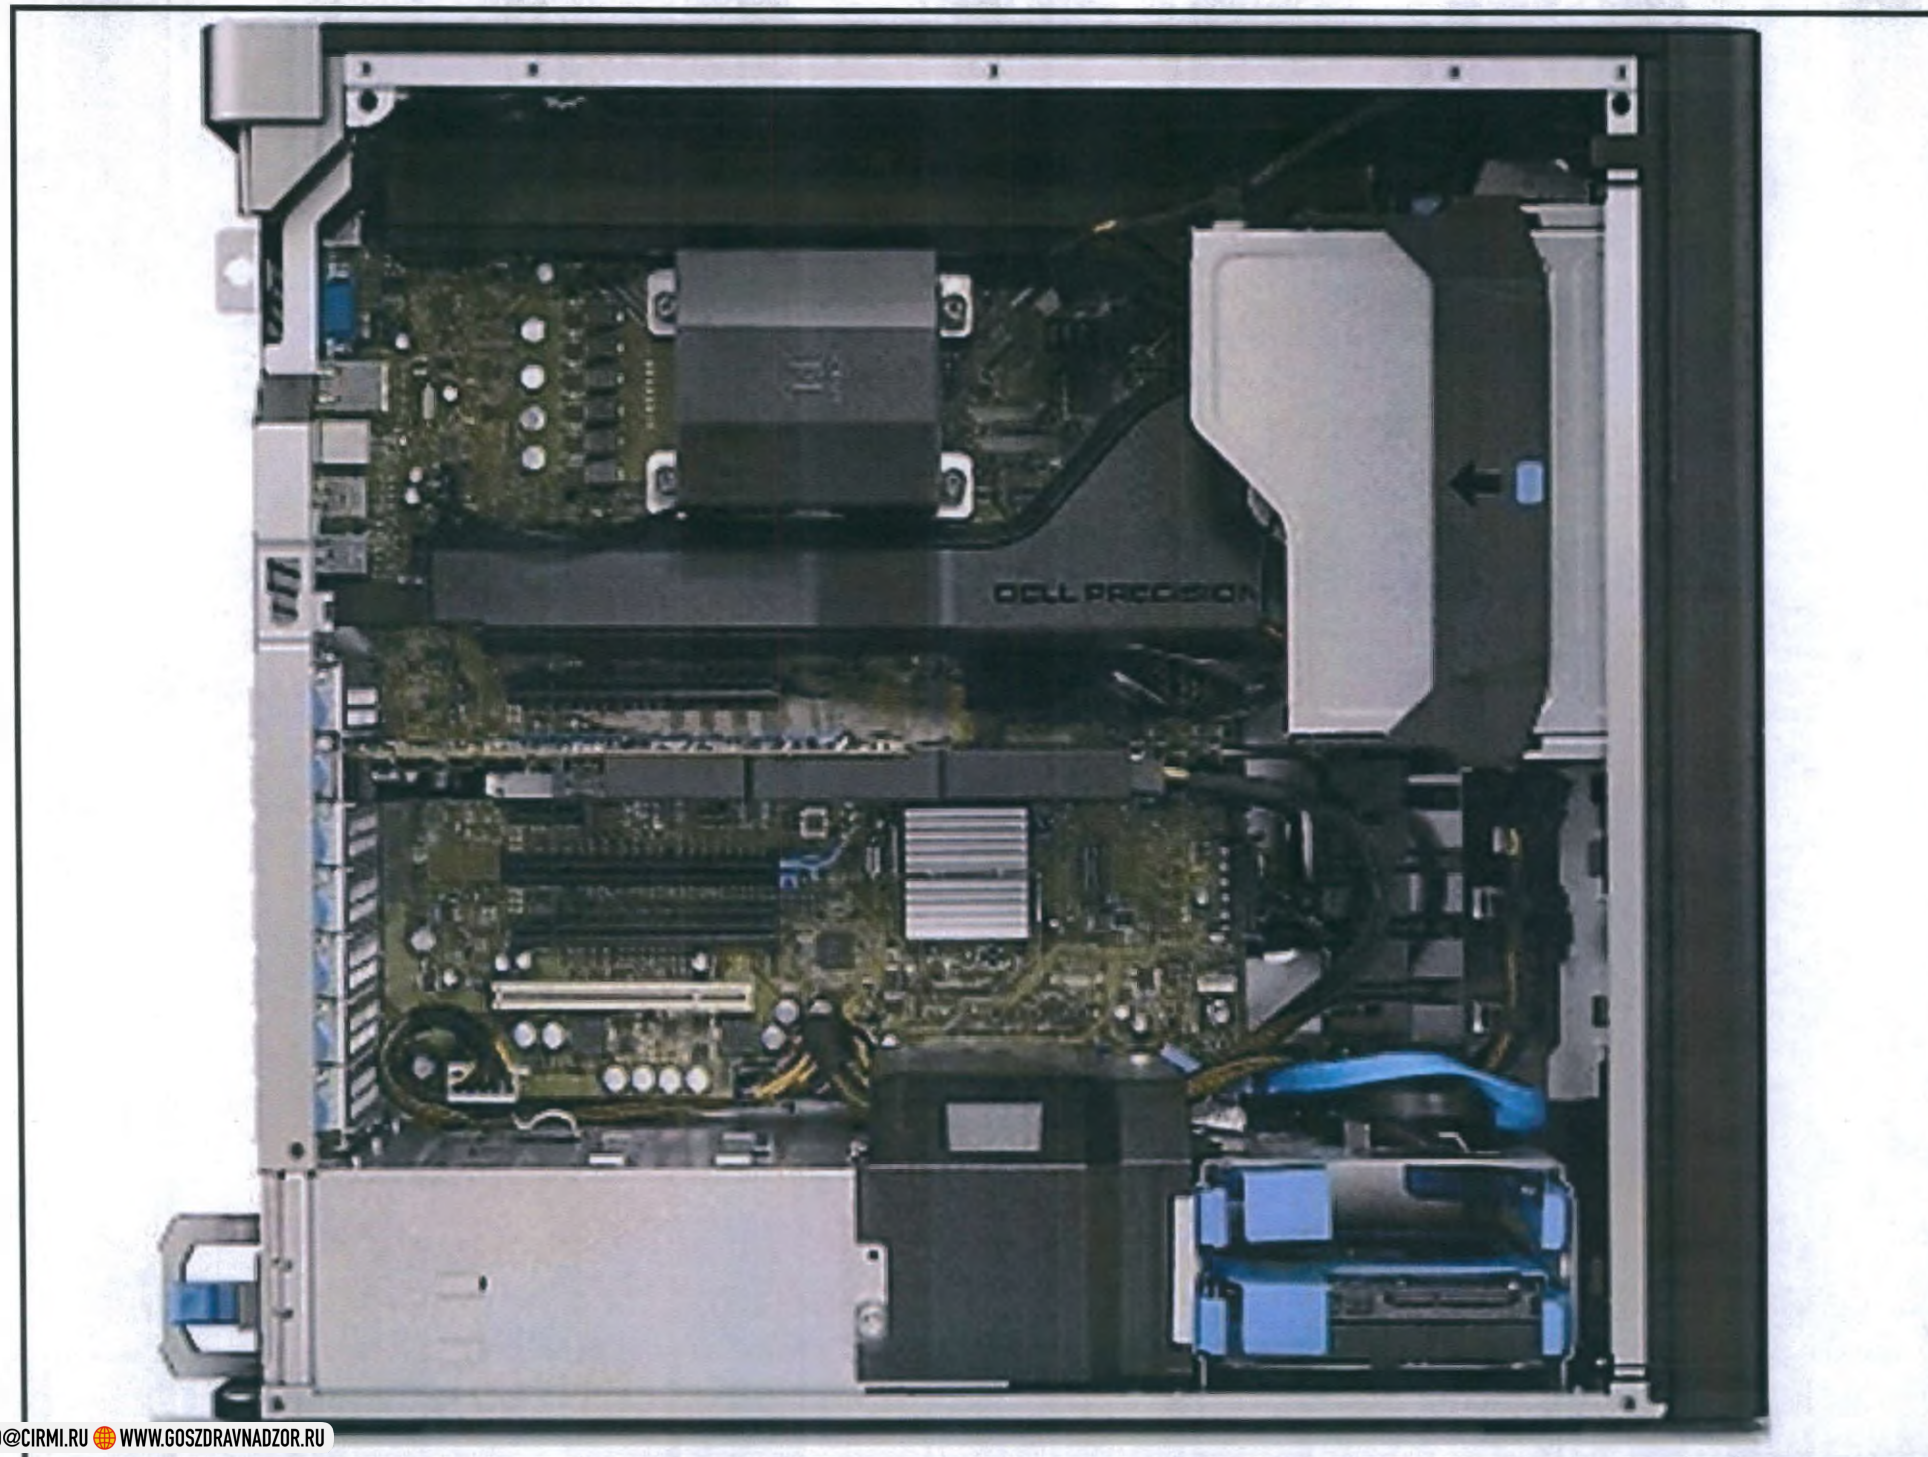

46. Вспомогательное оборудование для обработки результатов исследований (не более 5 шт.).




46. Вспомогательное оборудование для обработки результатов исследований (не более 5 шт.).

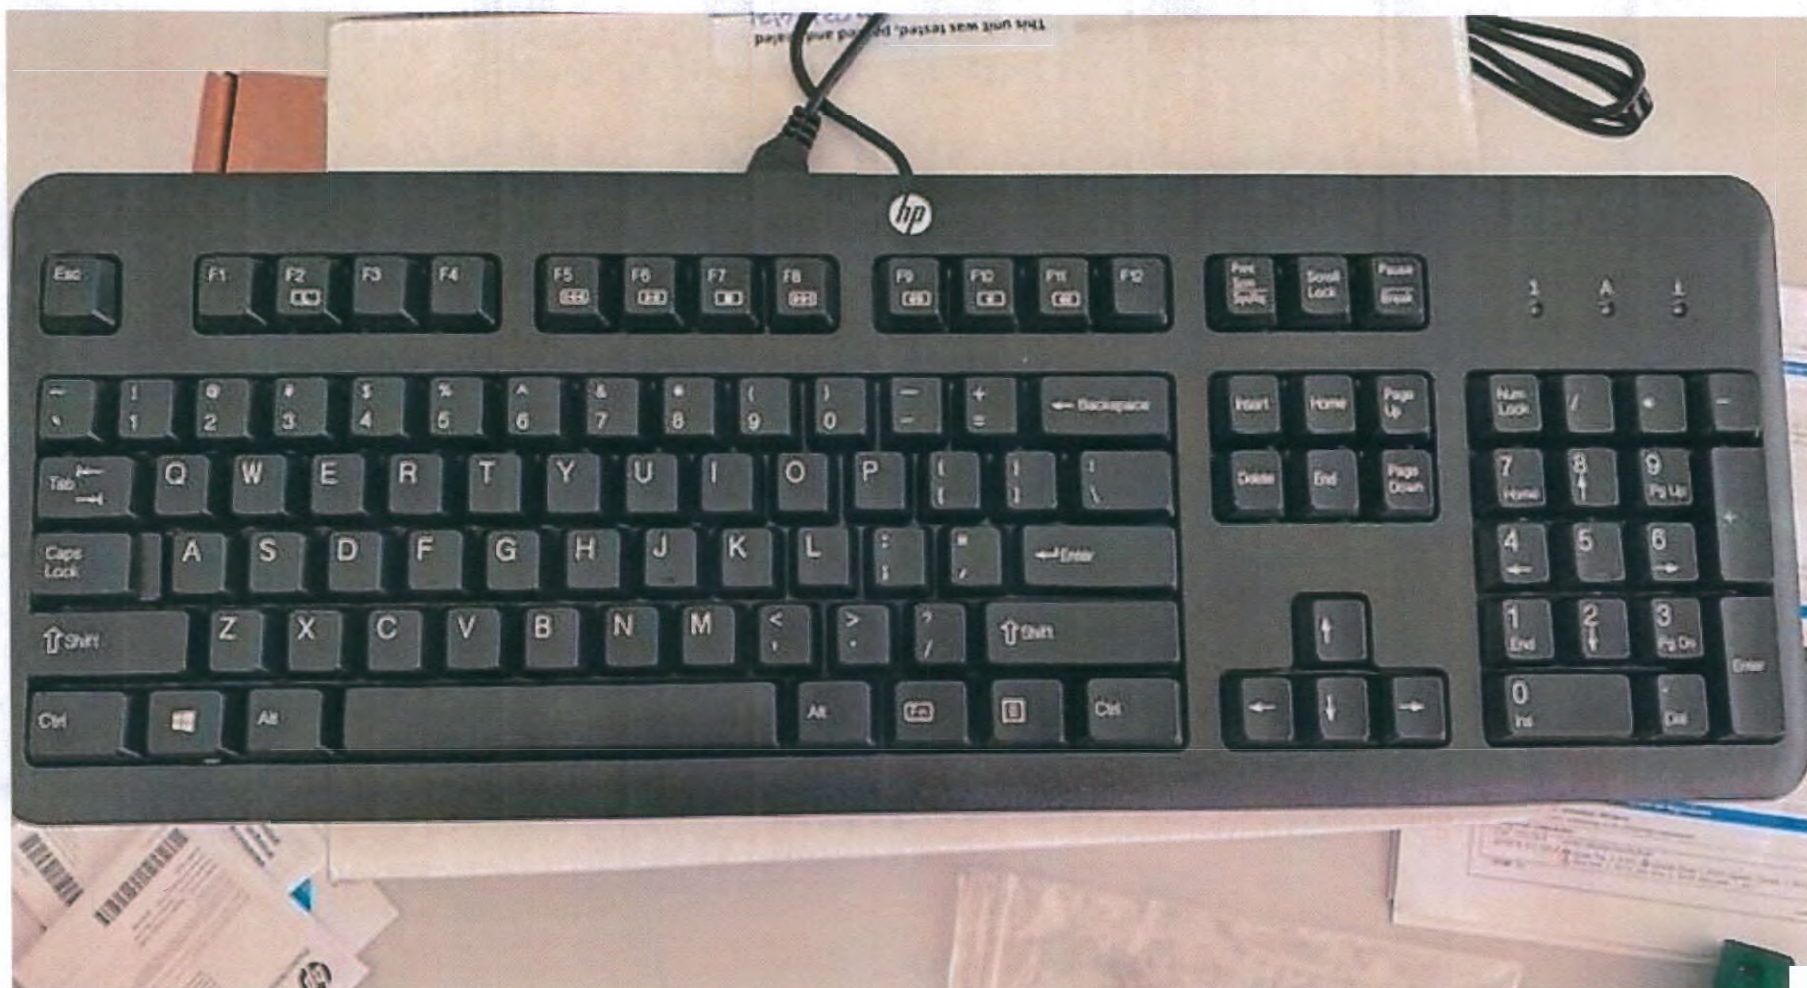

47. Шкафы для хранения катушек (не более 5 шт.).




48. Охлаждающая жидкость (не более 100 шт.).

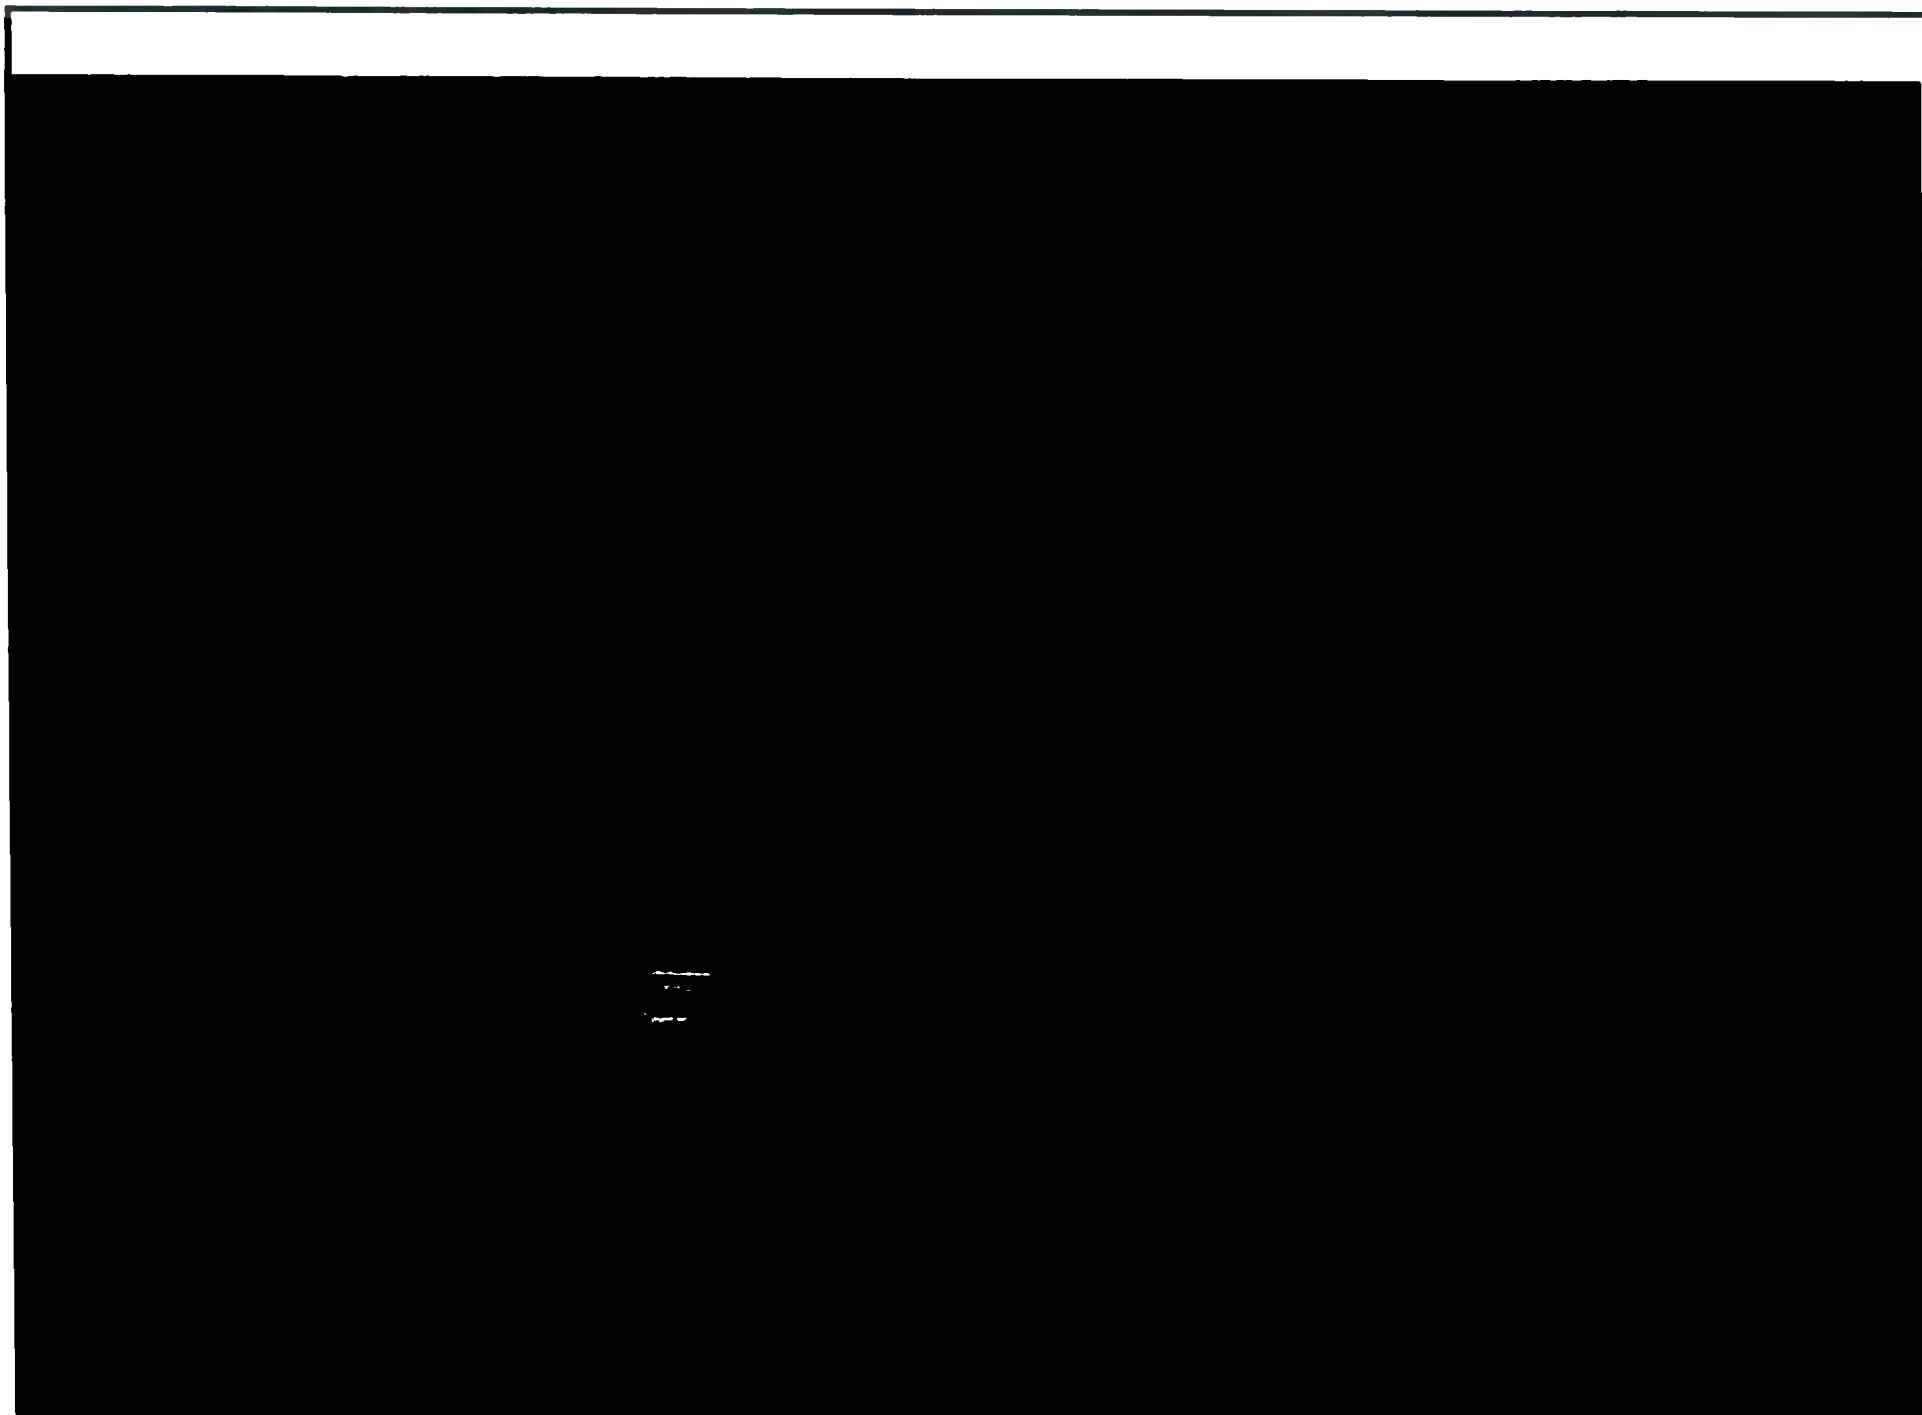






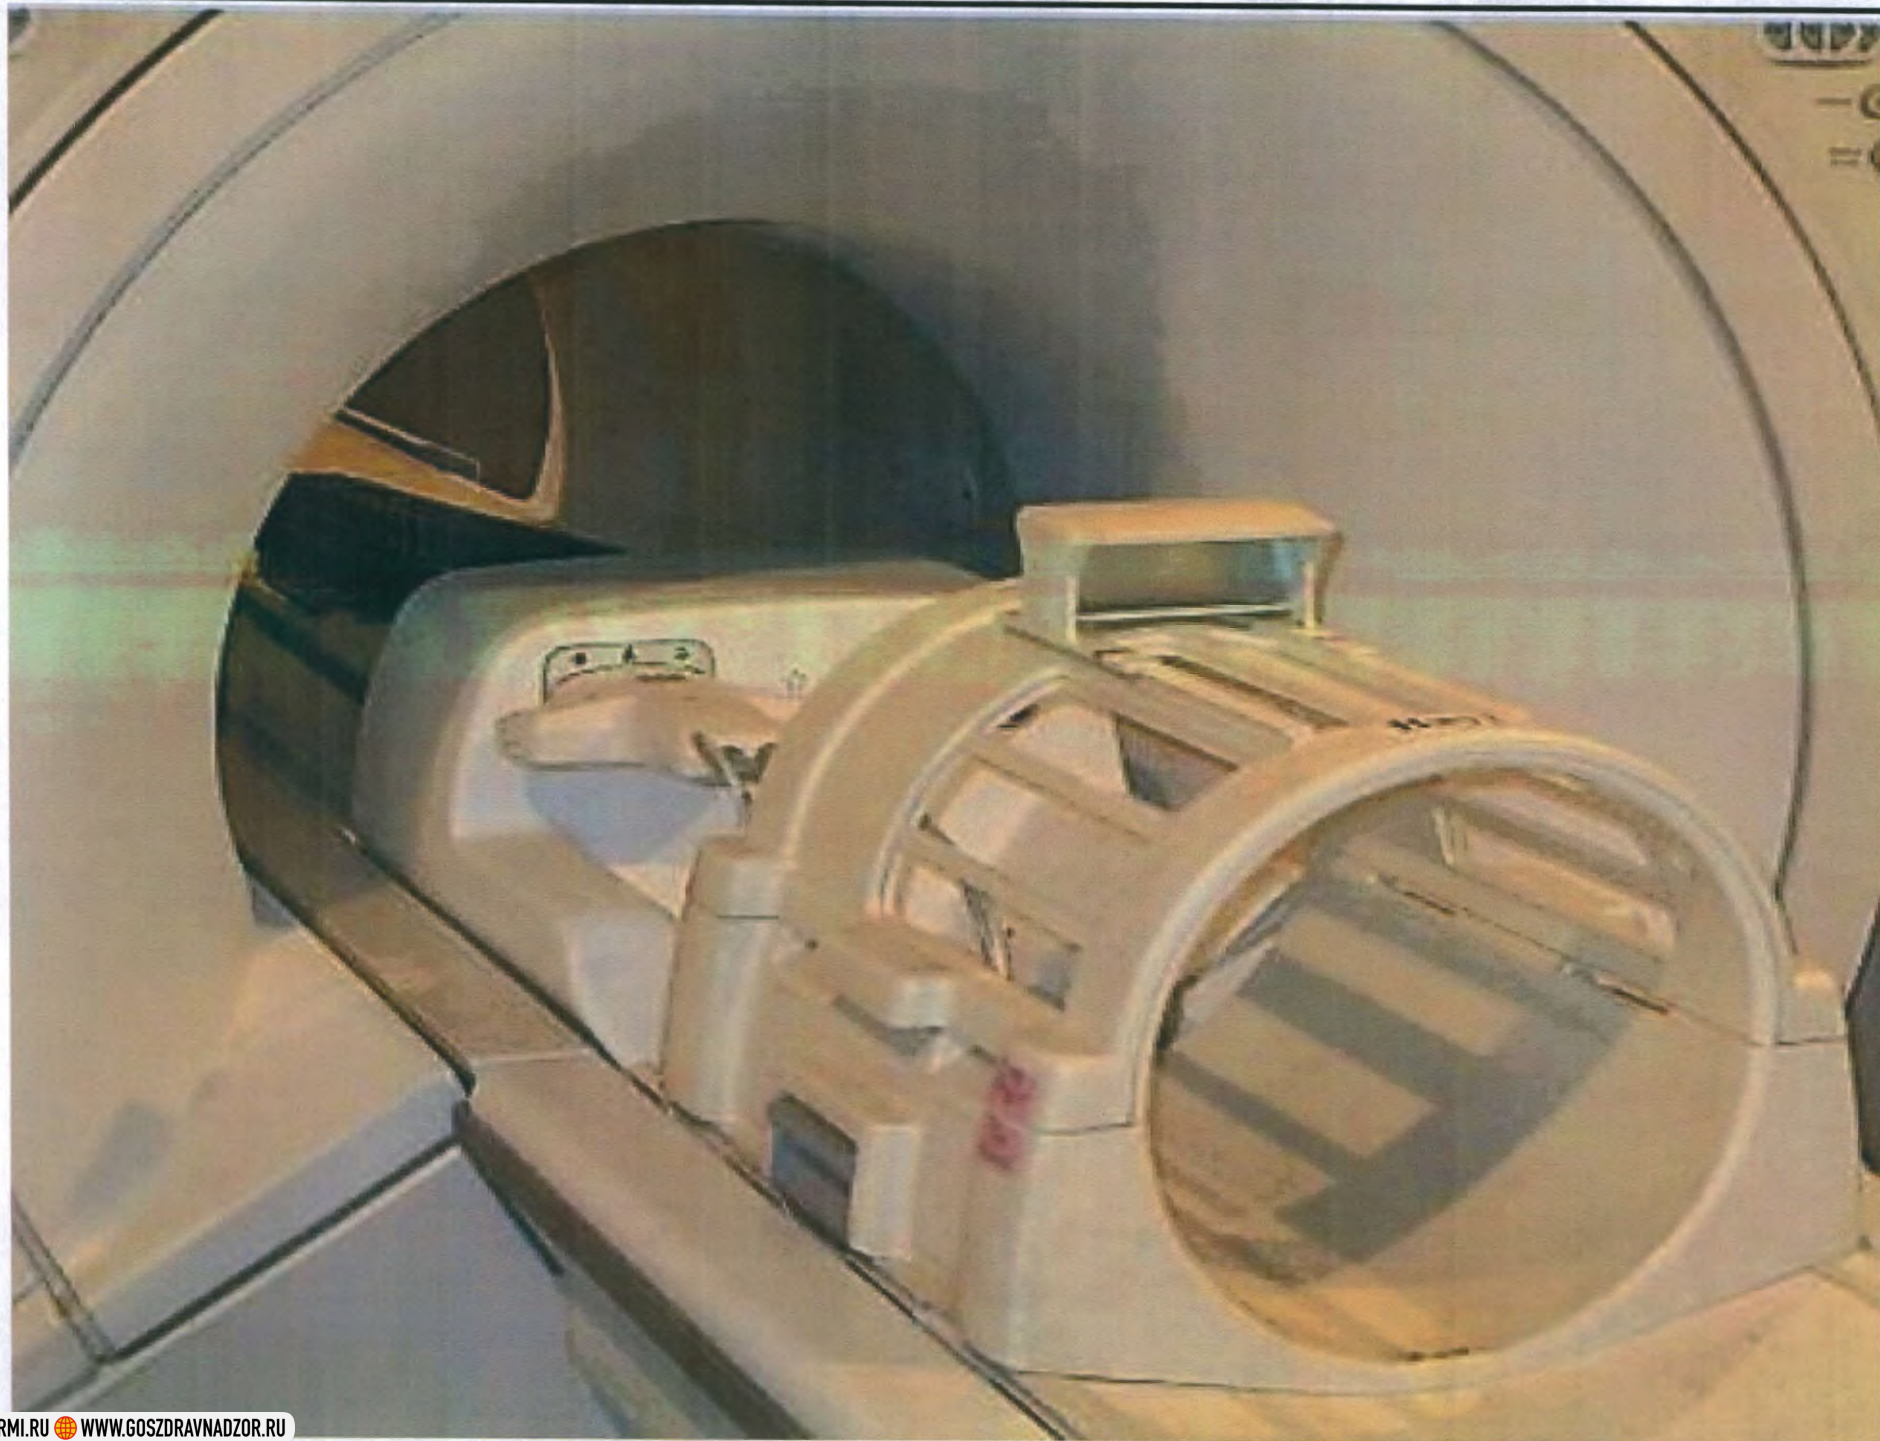

50. Датчики кислорода (не более 5 шт.).

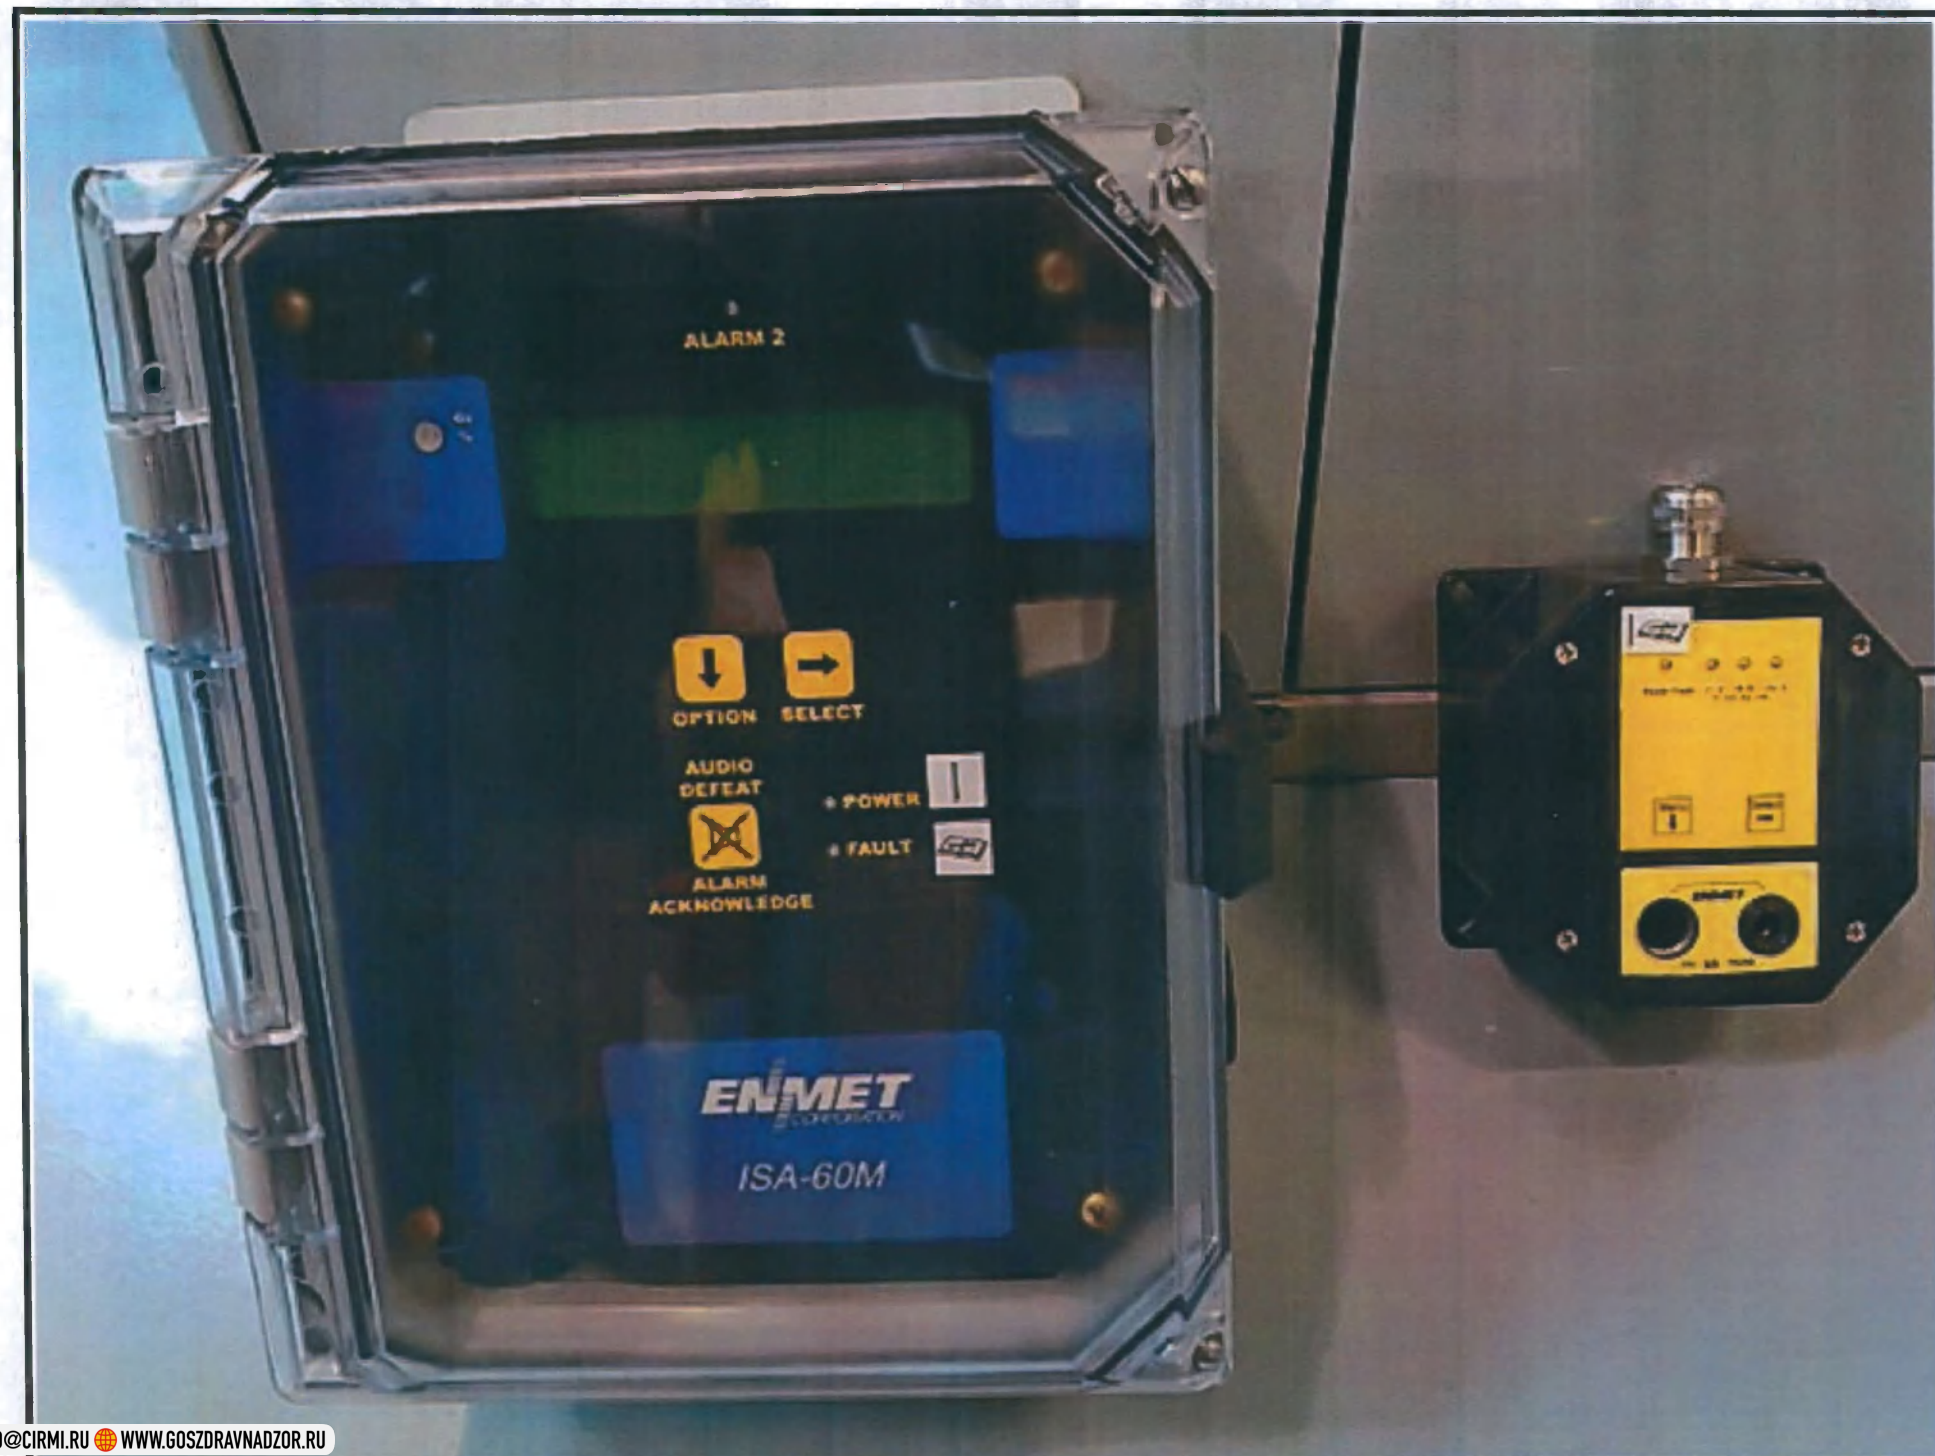

50. Датчики кислорода (не более 5 шт.).





50. Датчики кислорода (не более 5 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).




51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

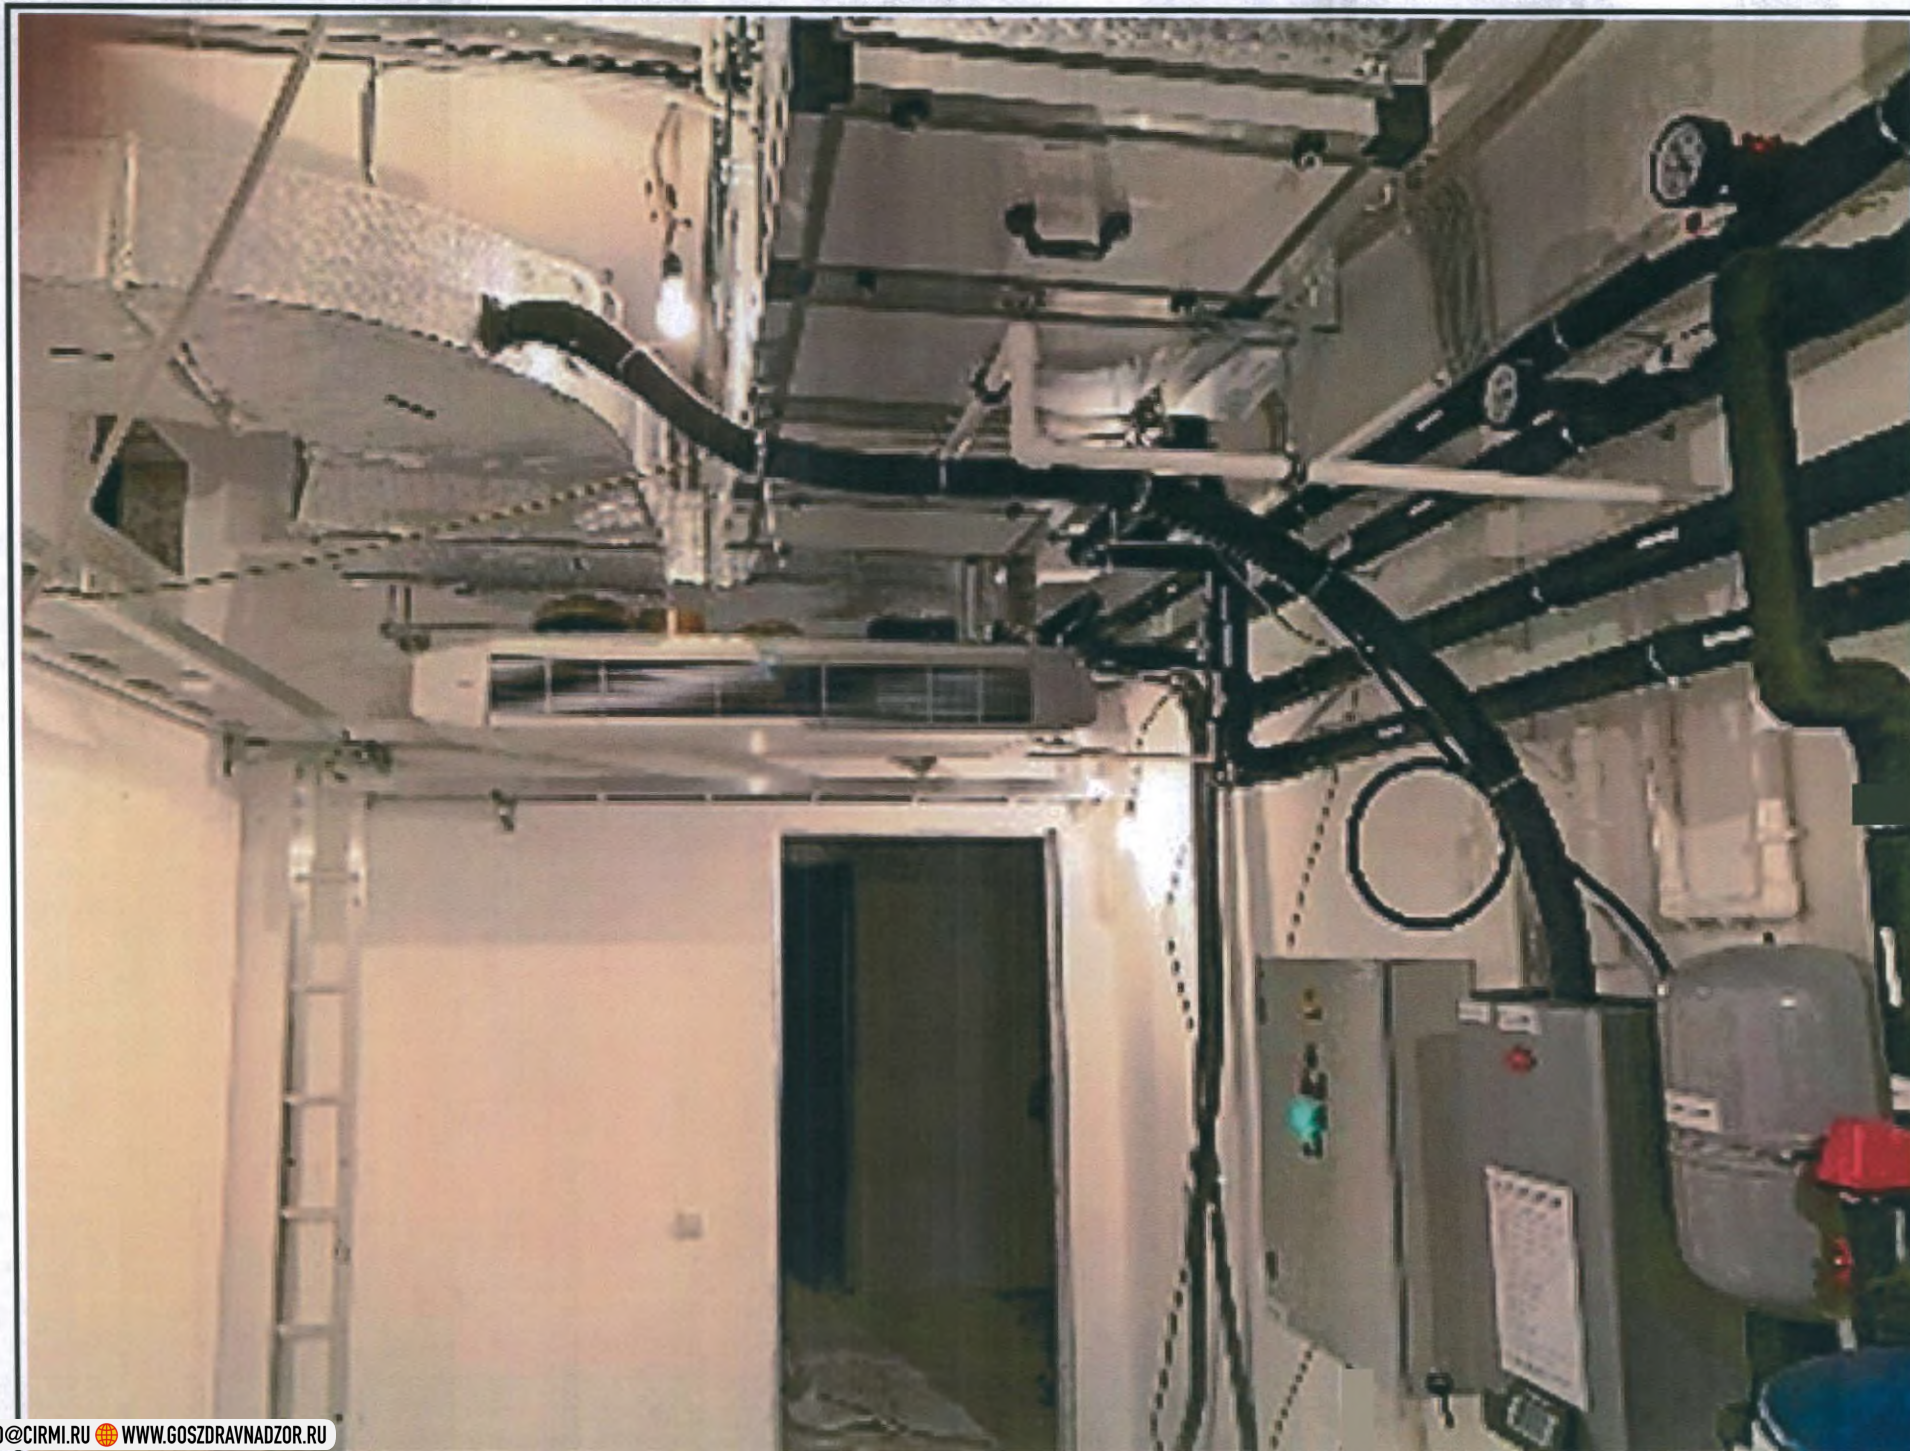


51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).




51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

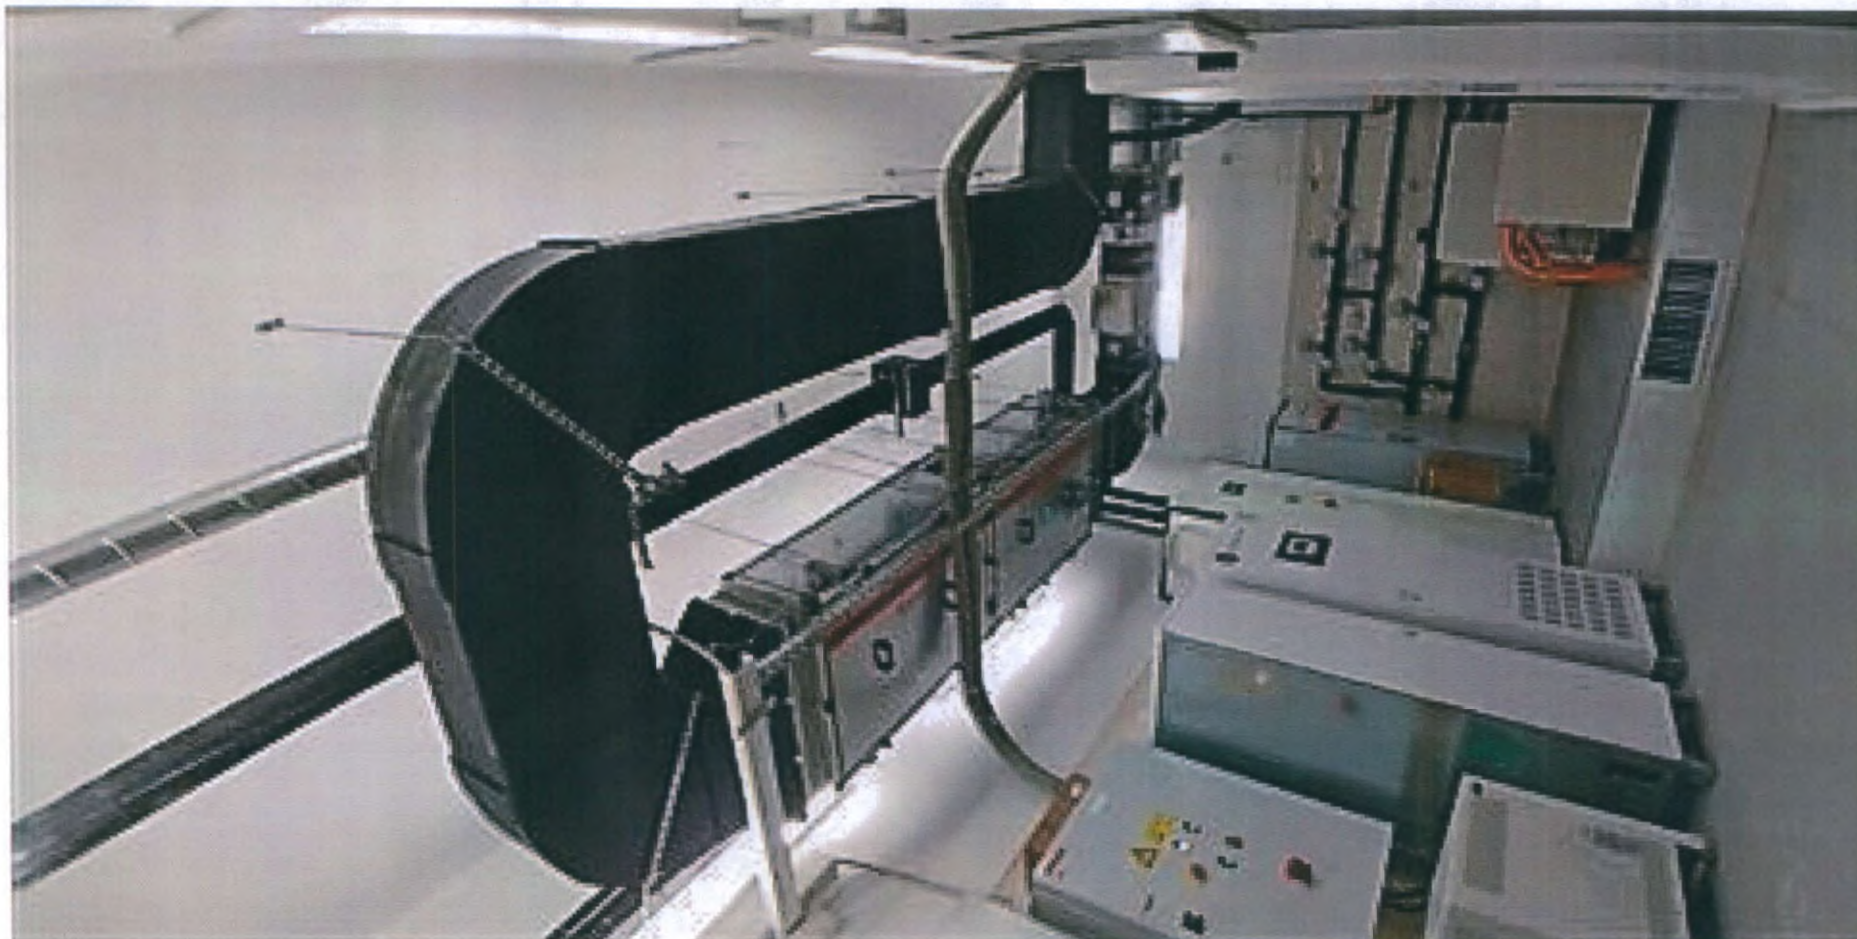

51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



51. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

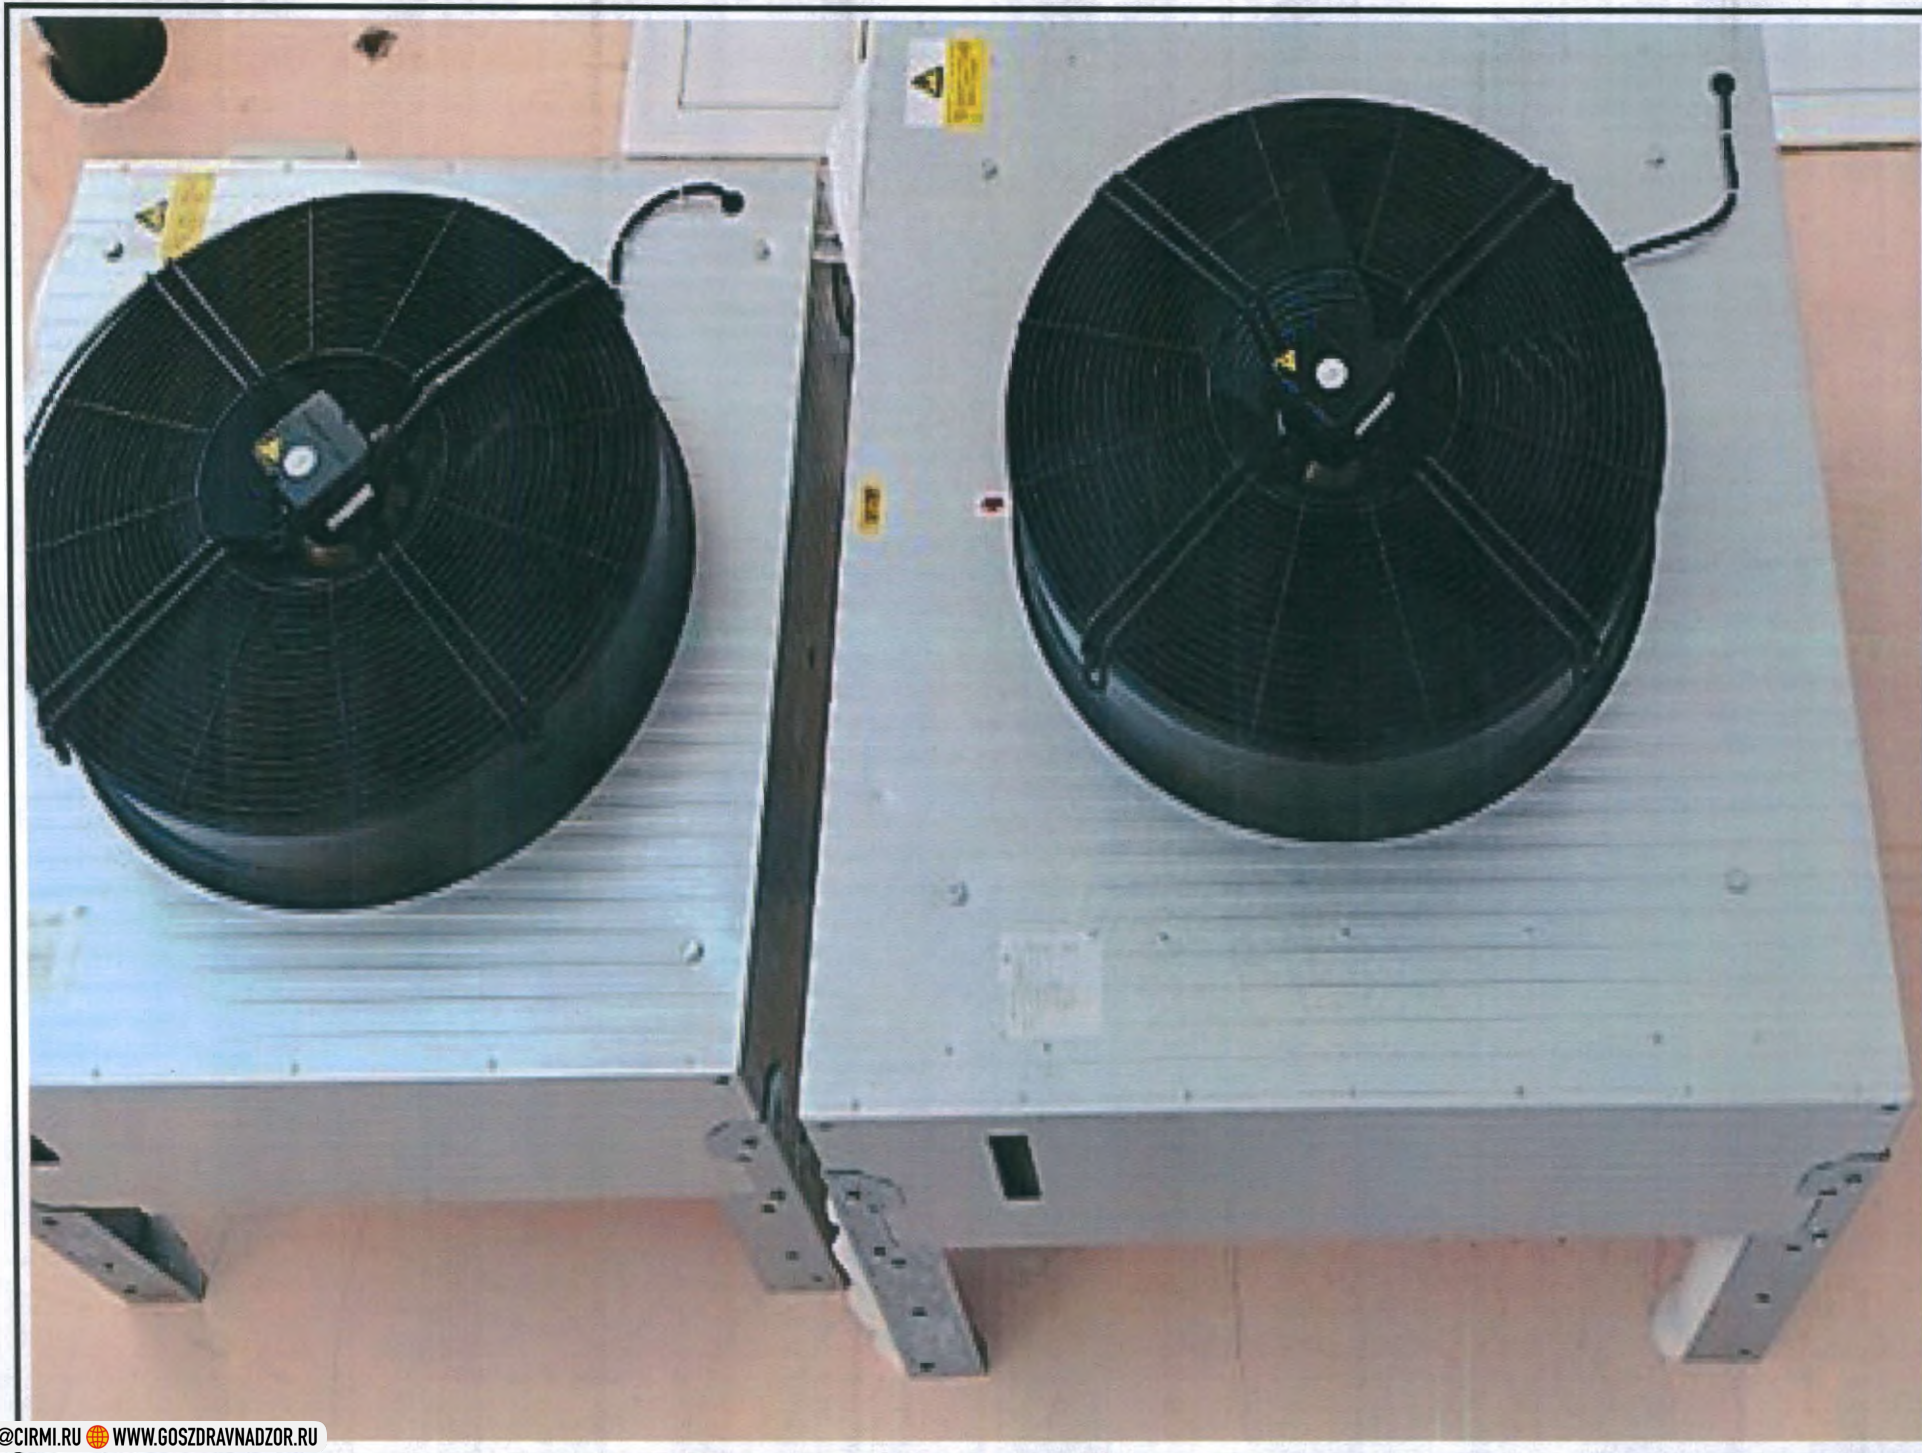



52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).



52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).




52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).



52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).



52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).

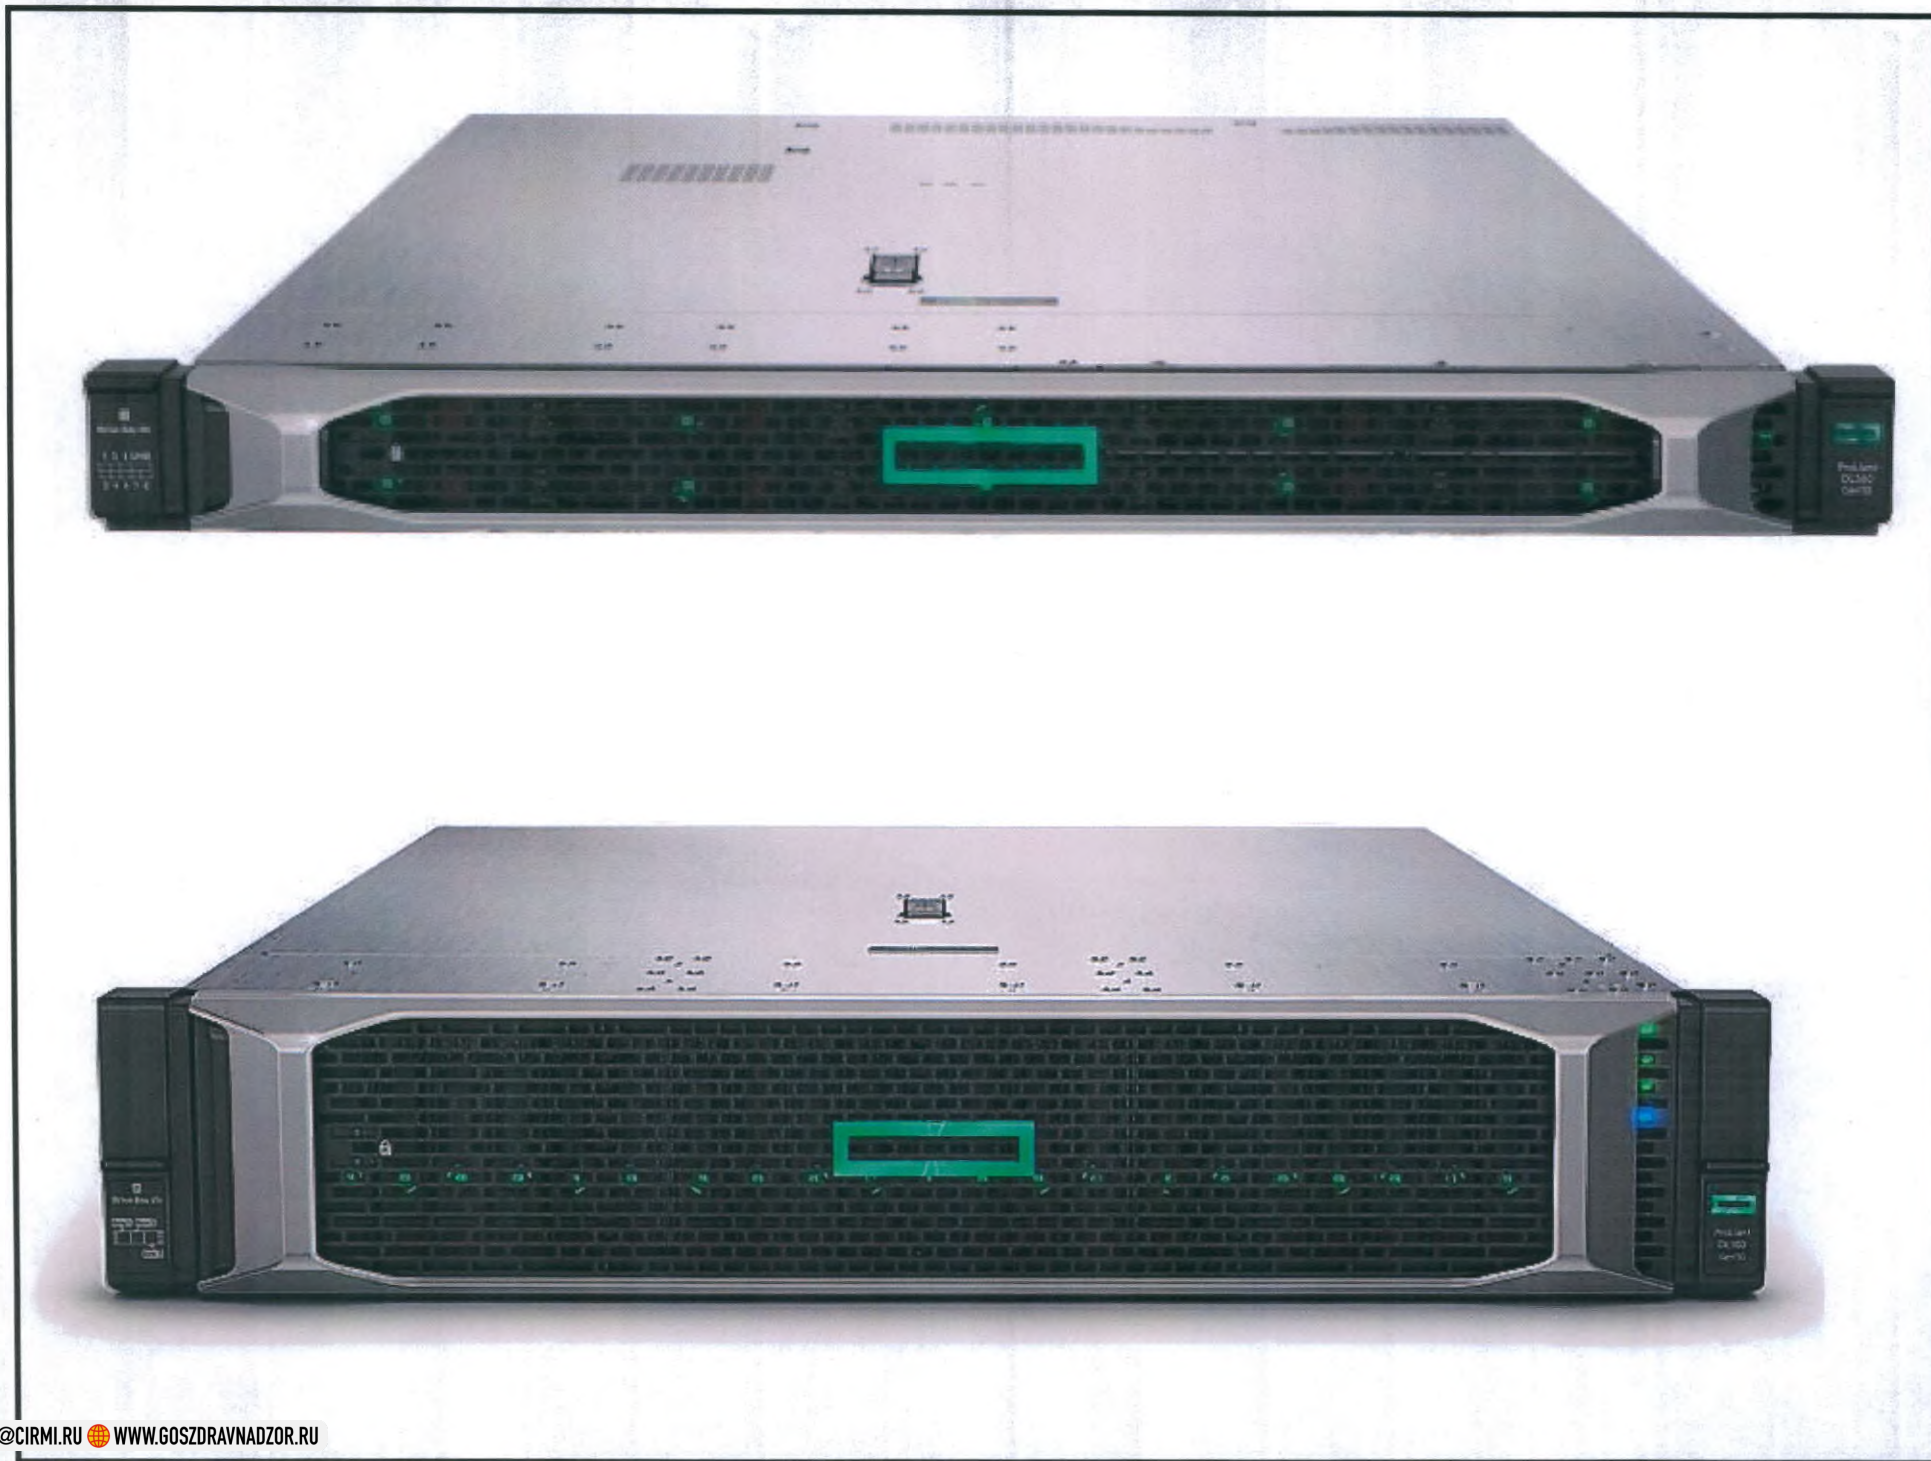


52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).




52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).



52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).

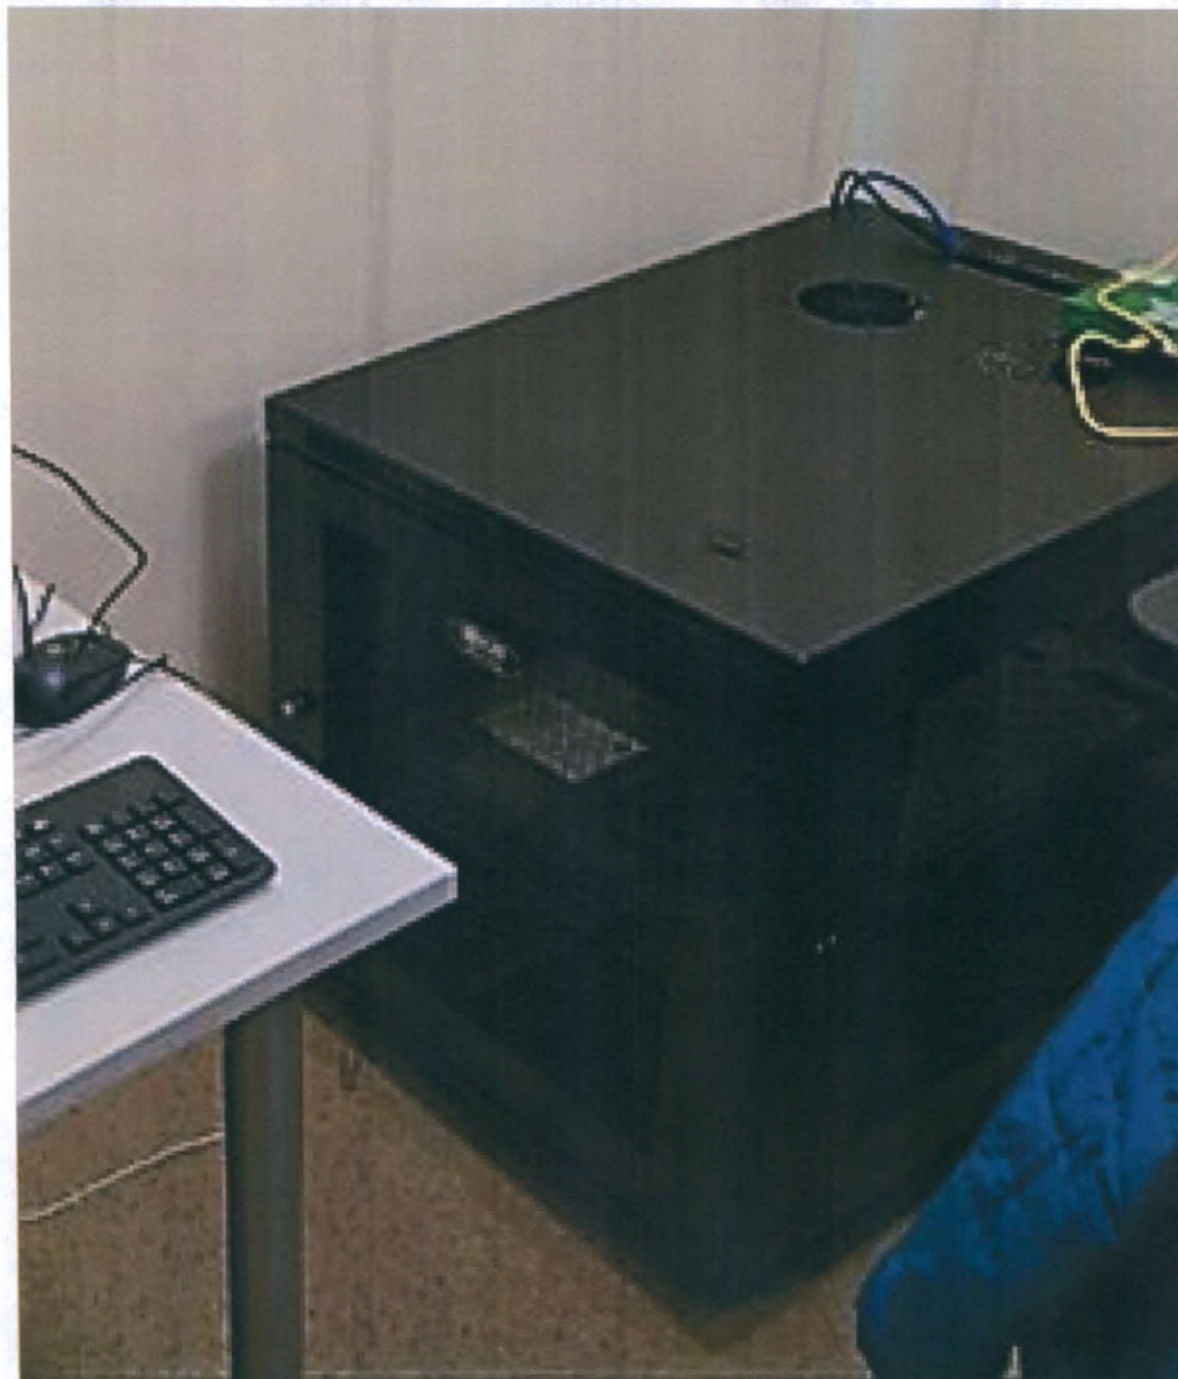

52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).

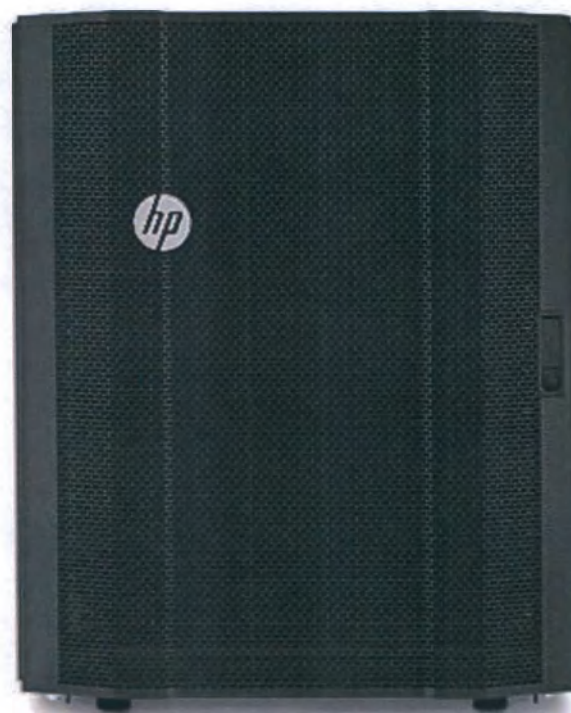


52. Рабочие станции врача для обработки данных серверного типа (не более 5 шт.).





53. Устройства для контроллера получения физиологических данных (не более 20 шт.).

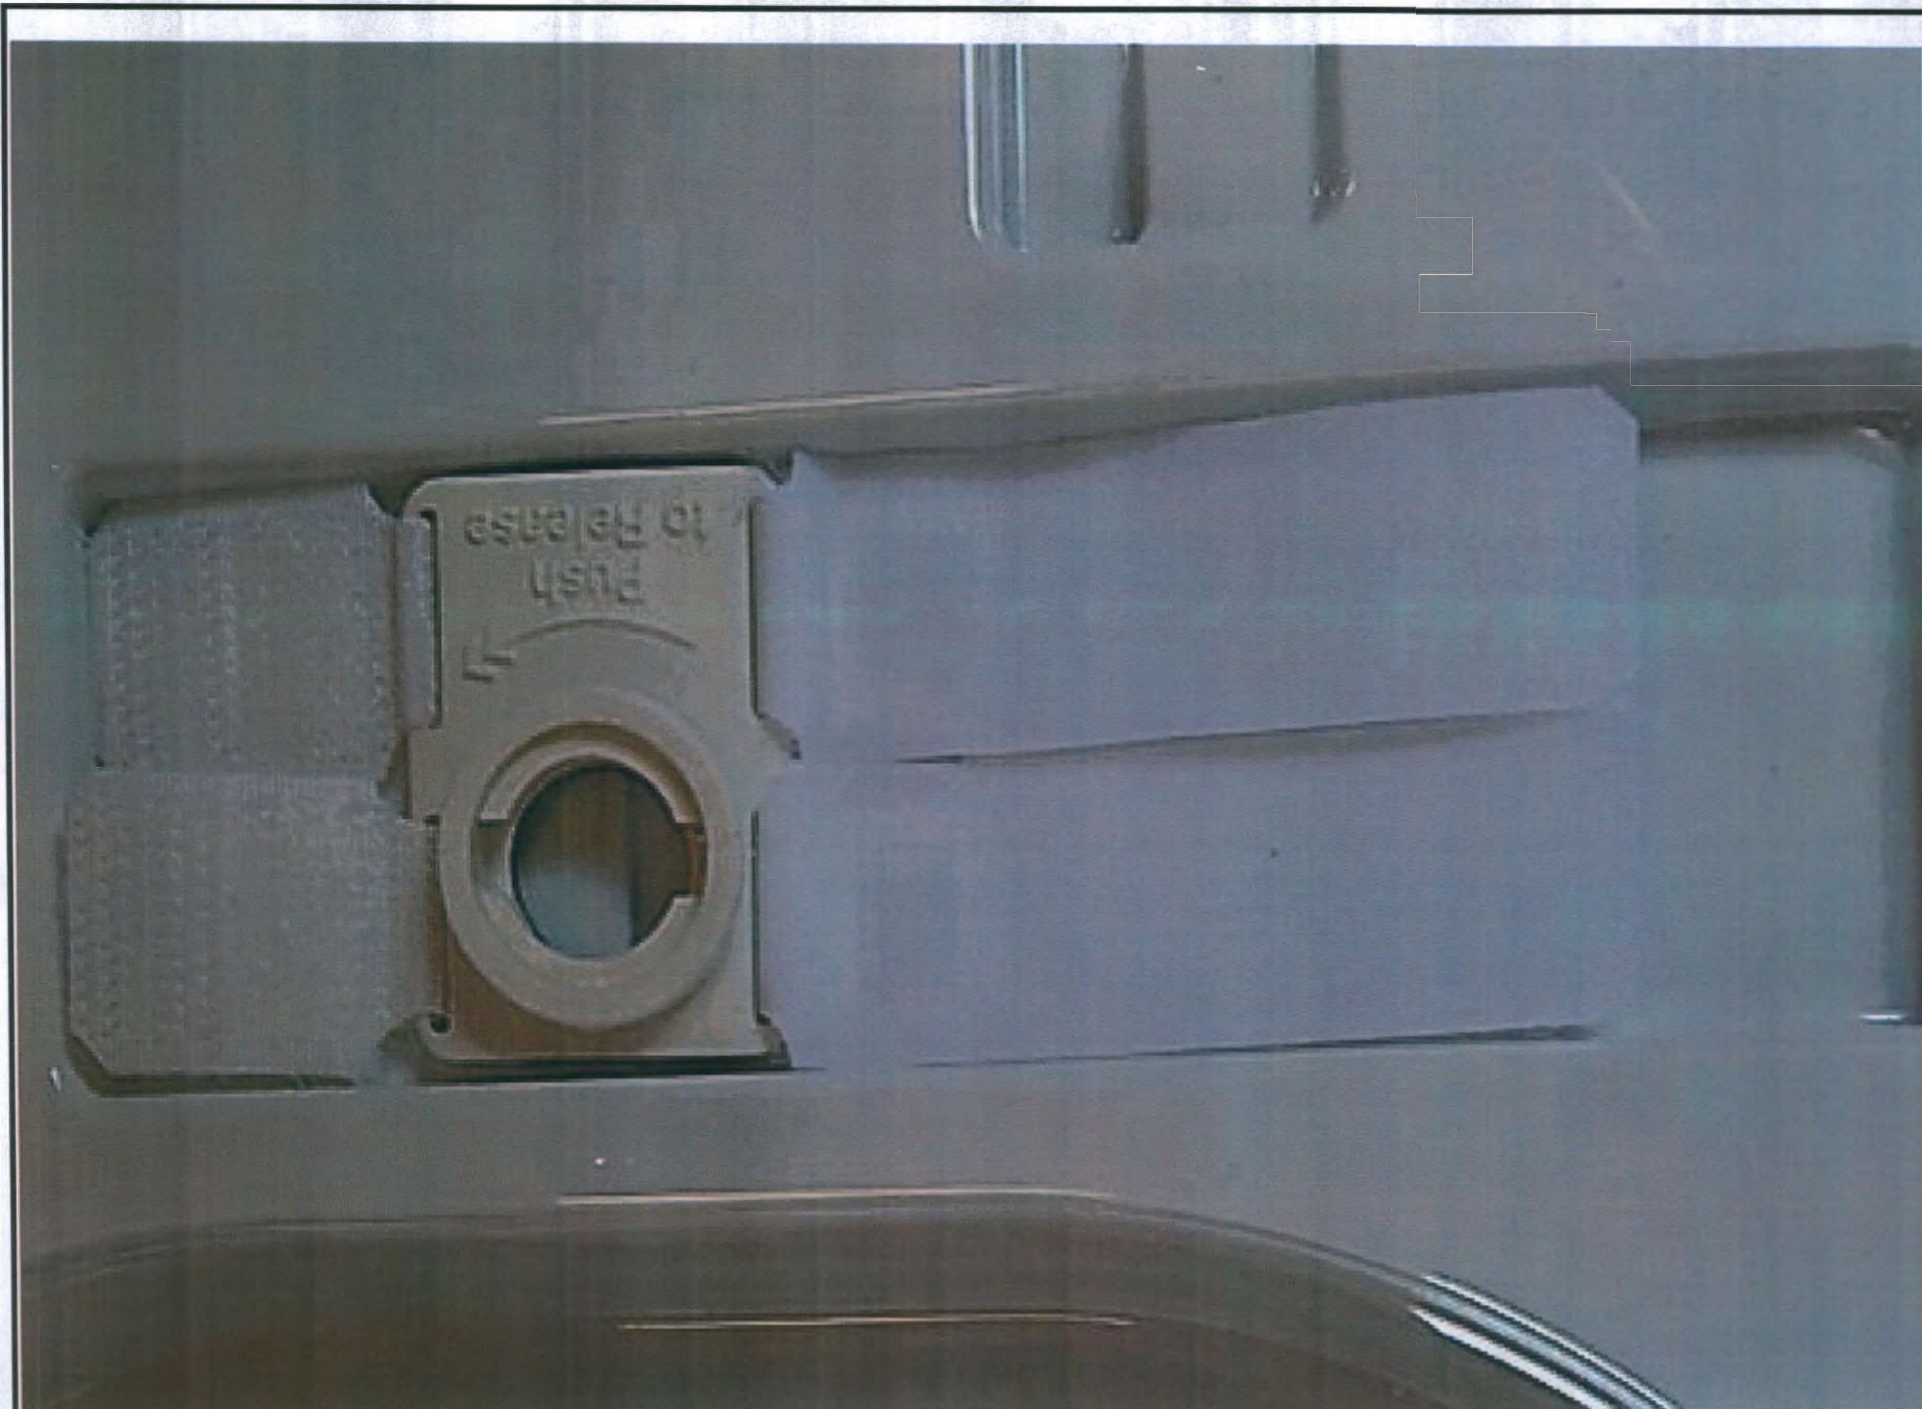


53. Устройства для контроллера получения физиологических данных (не более 20 шт.).



53. Устройства для контроллера получения физиологических данных (не более 20 шт.).




54. Периферийные устройства (не более 10 шт.).

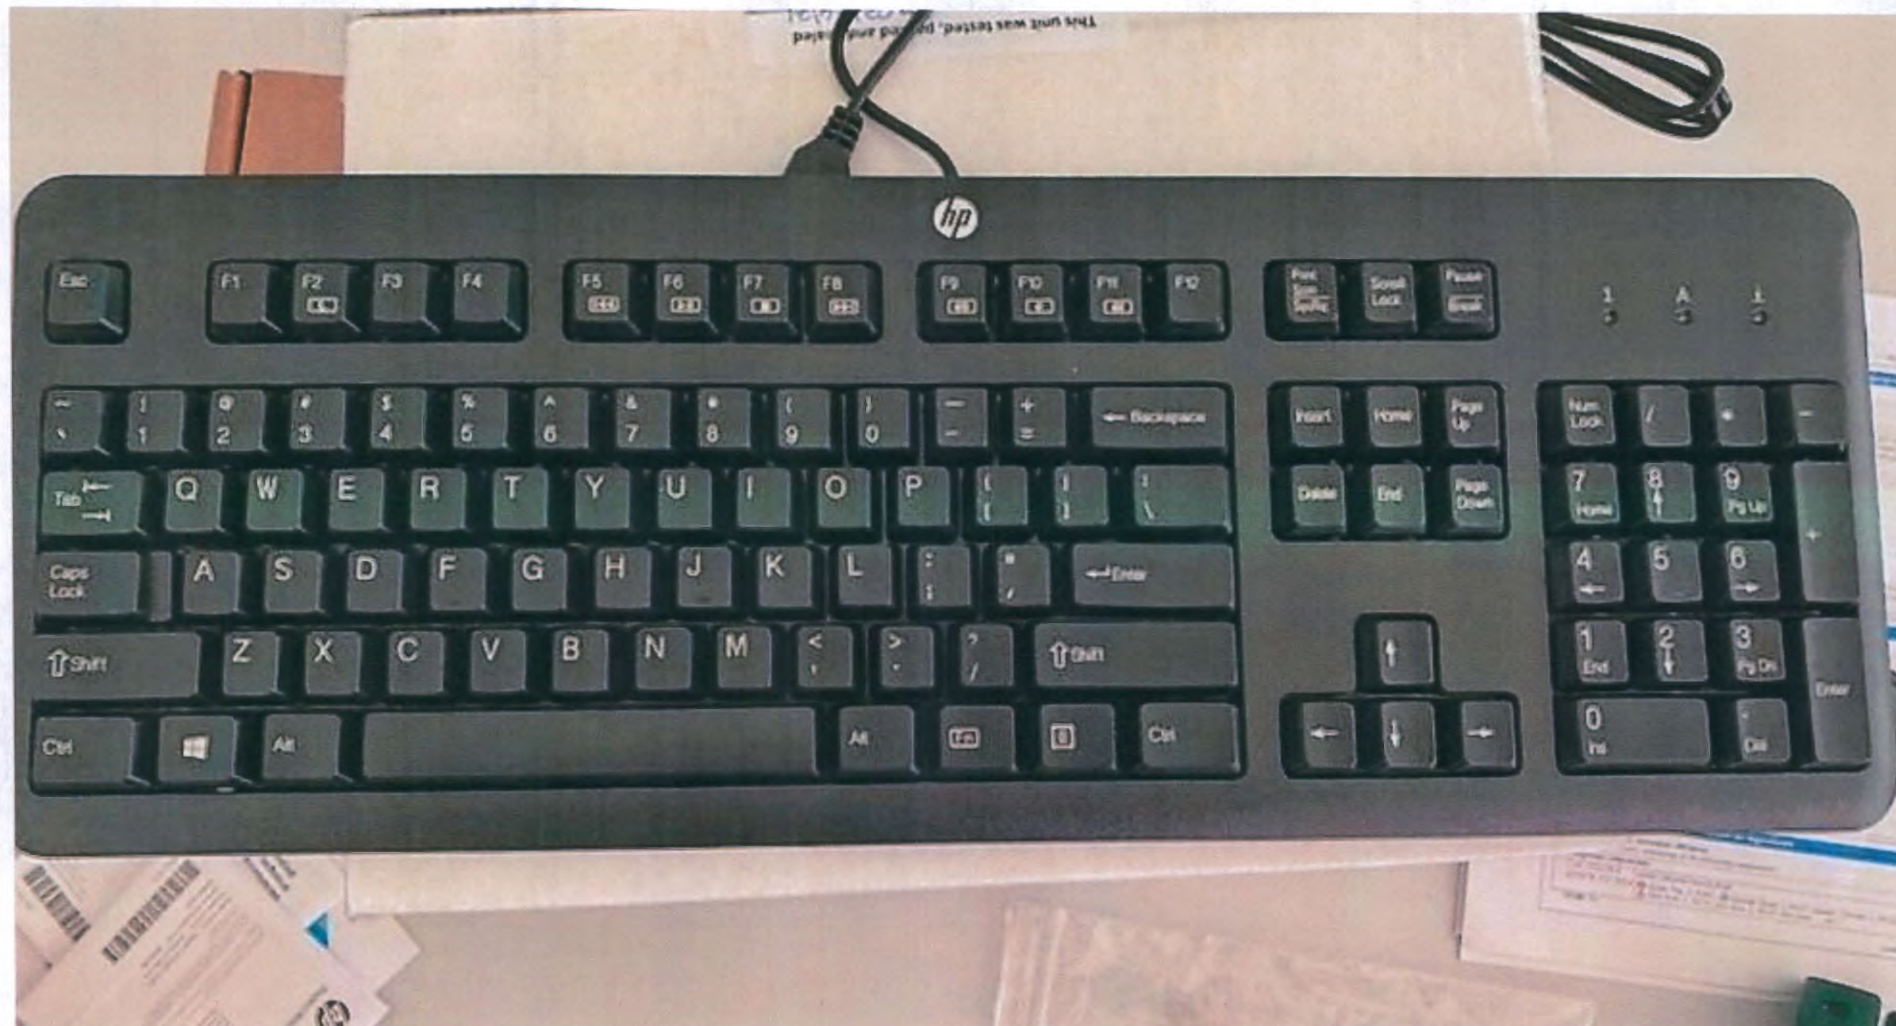



54. Периферийные устройства (не более 10 шт.).






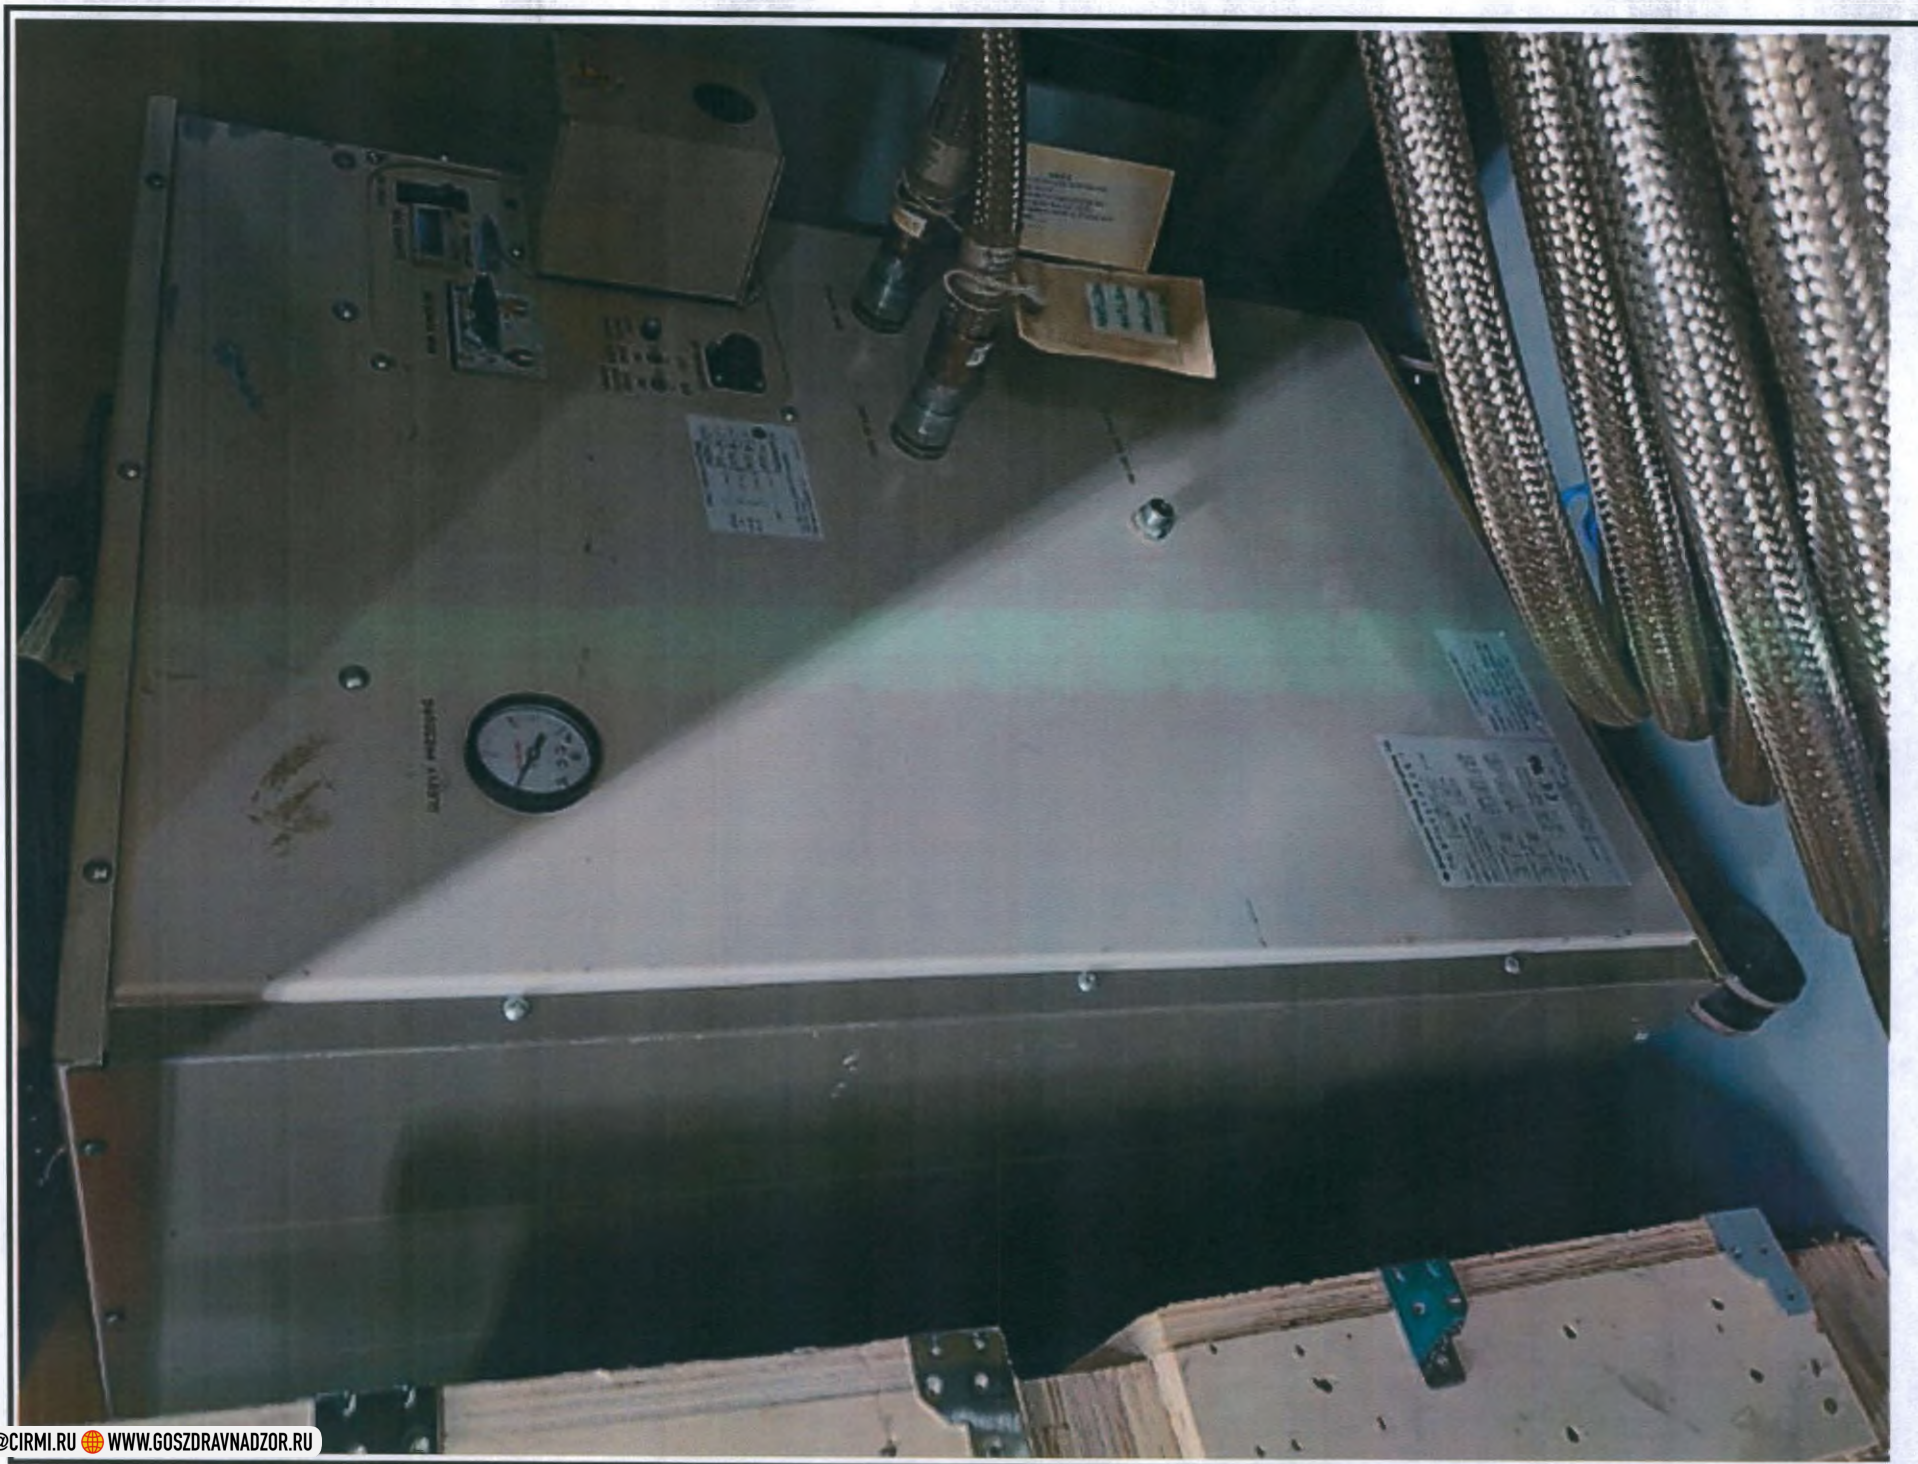

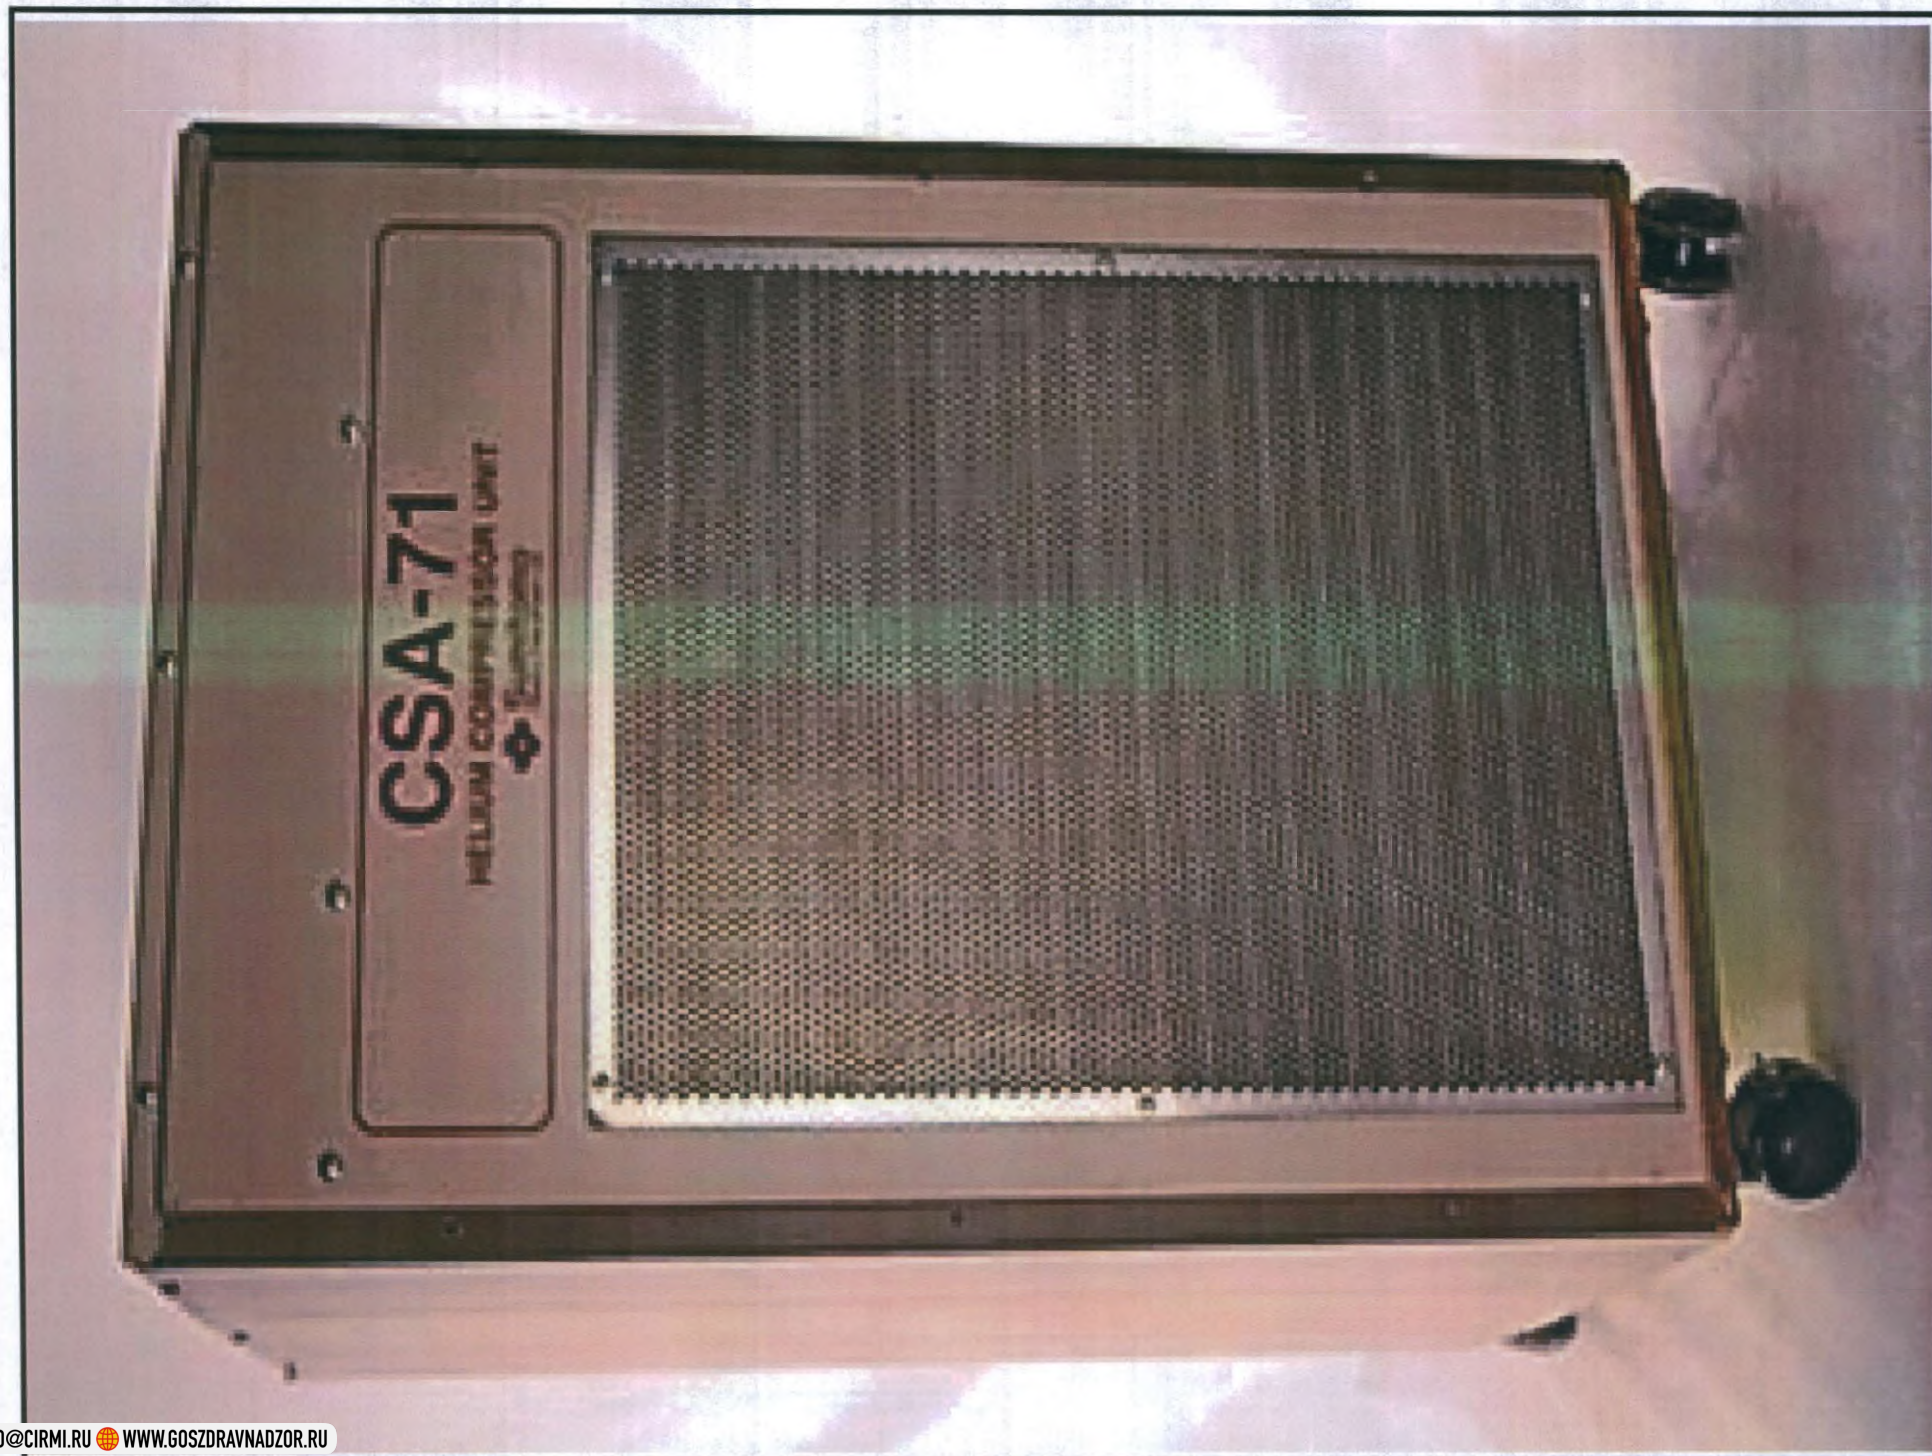


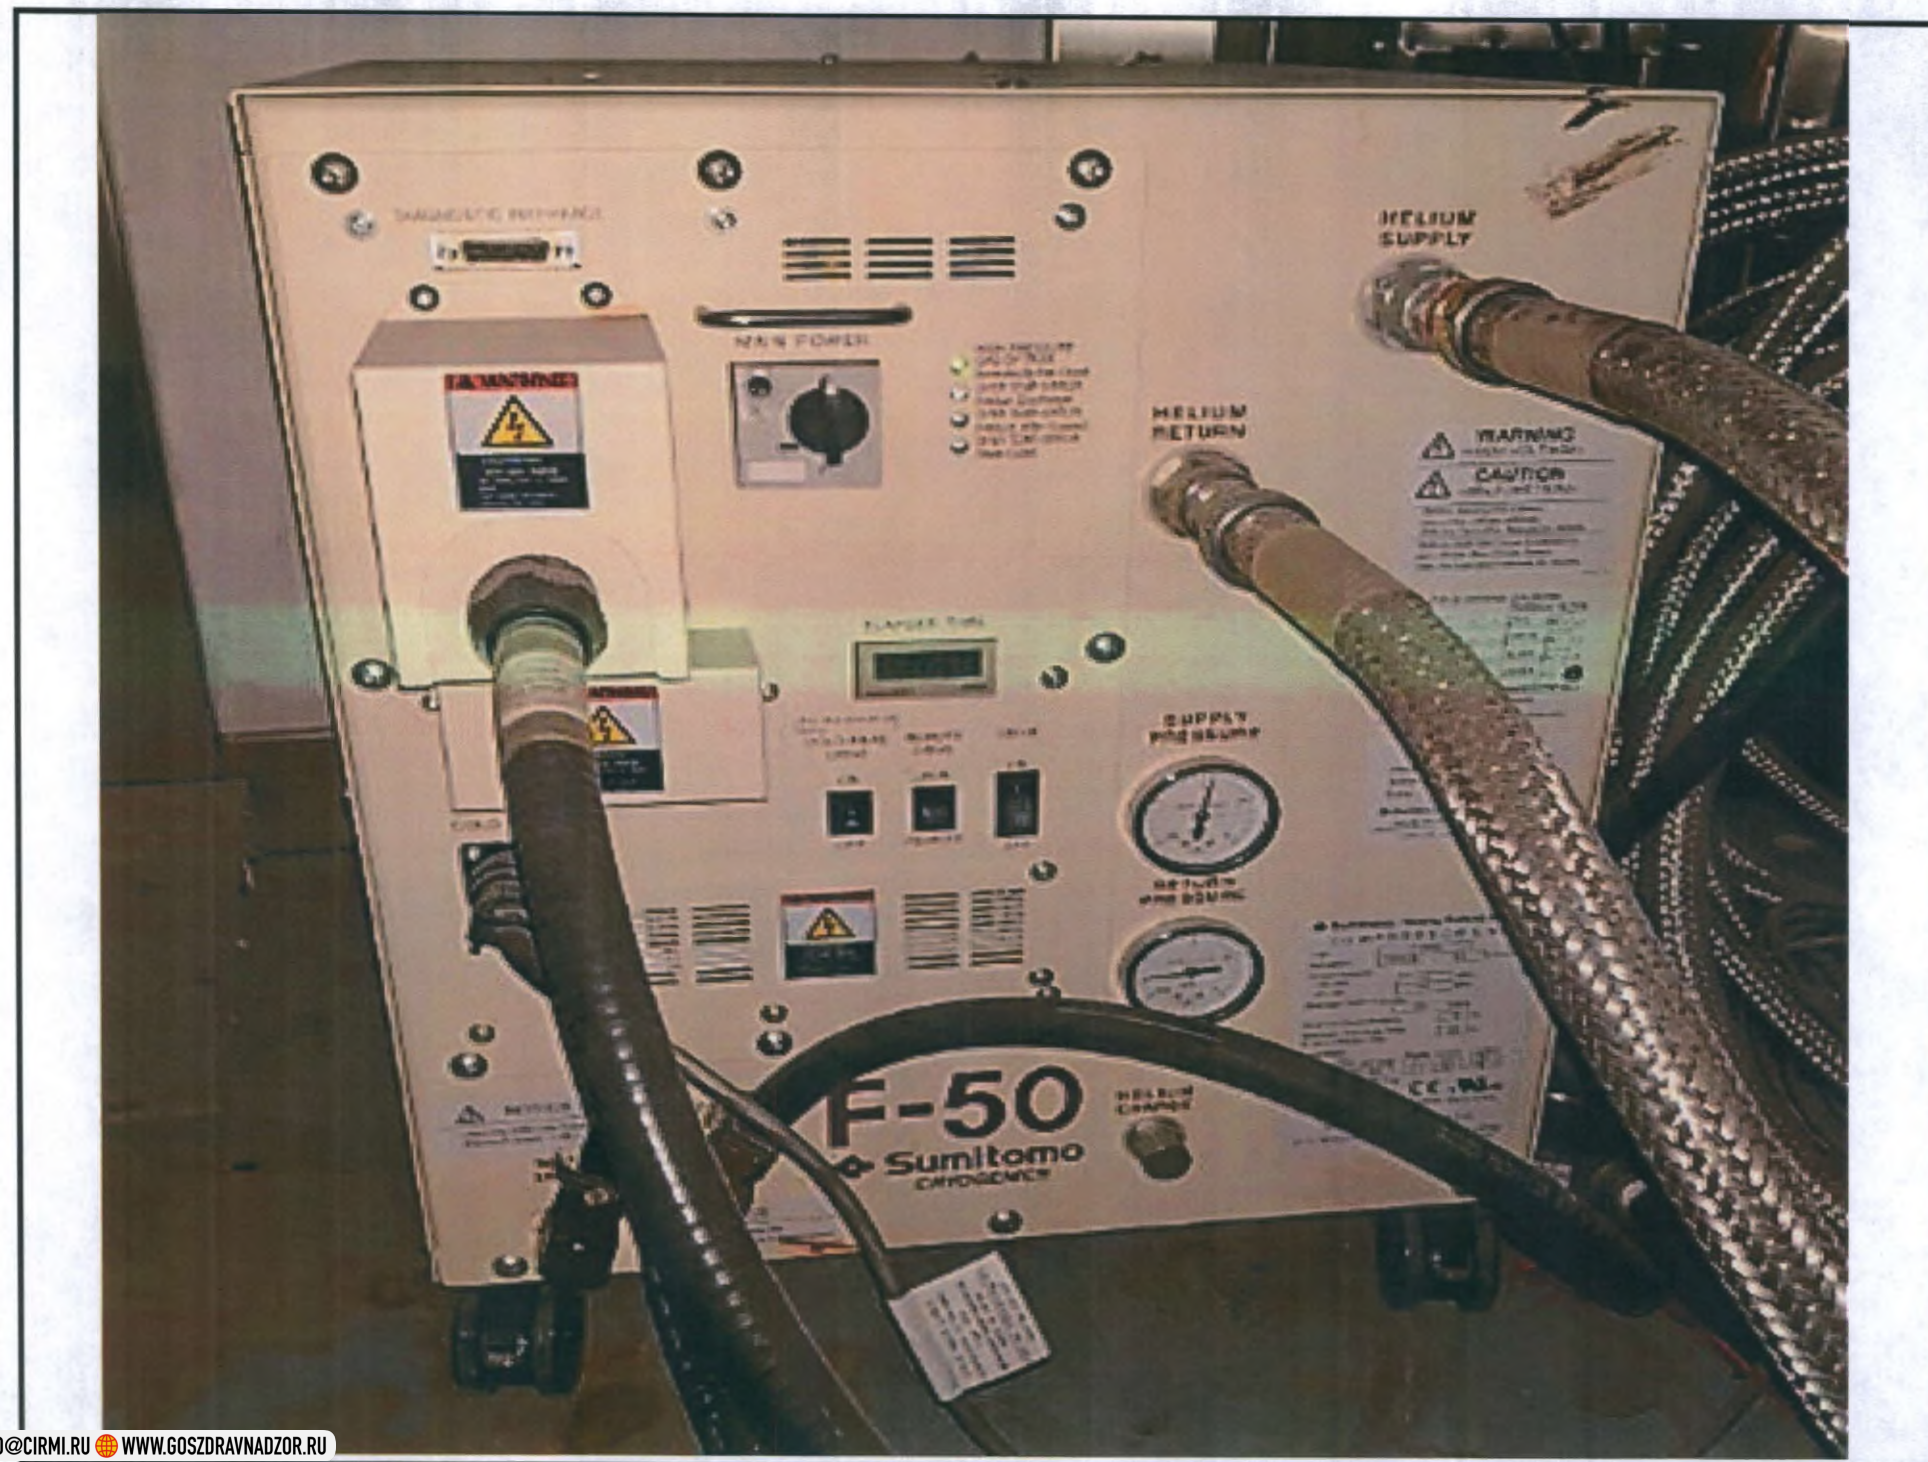


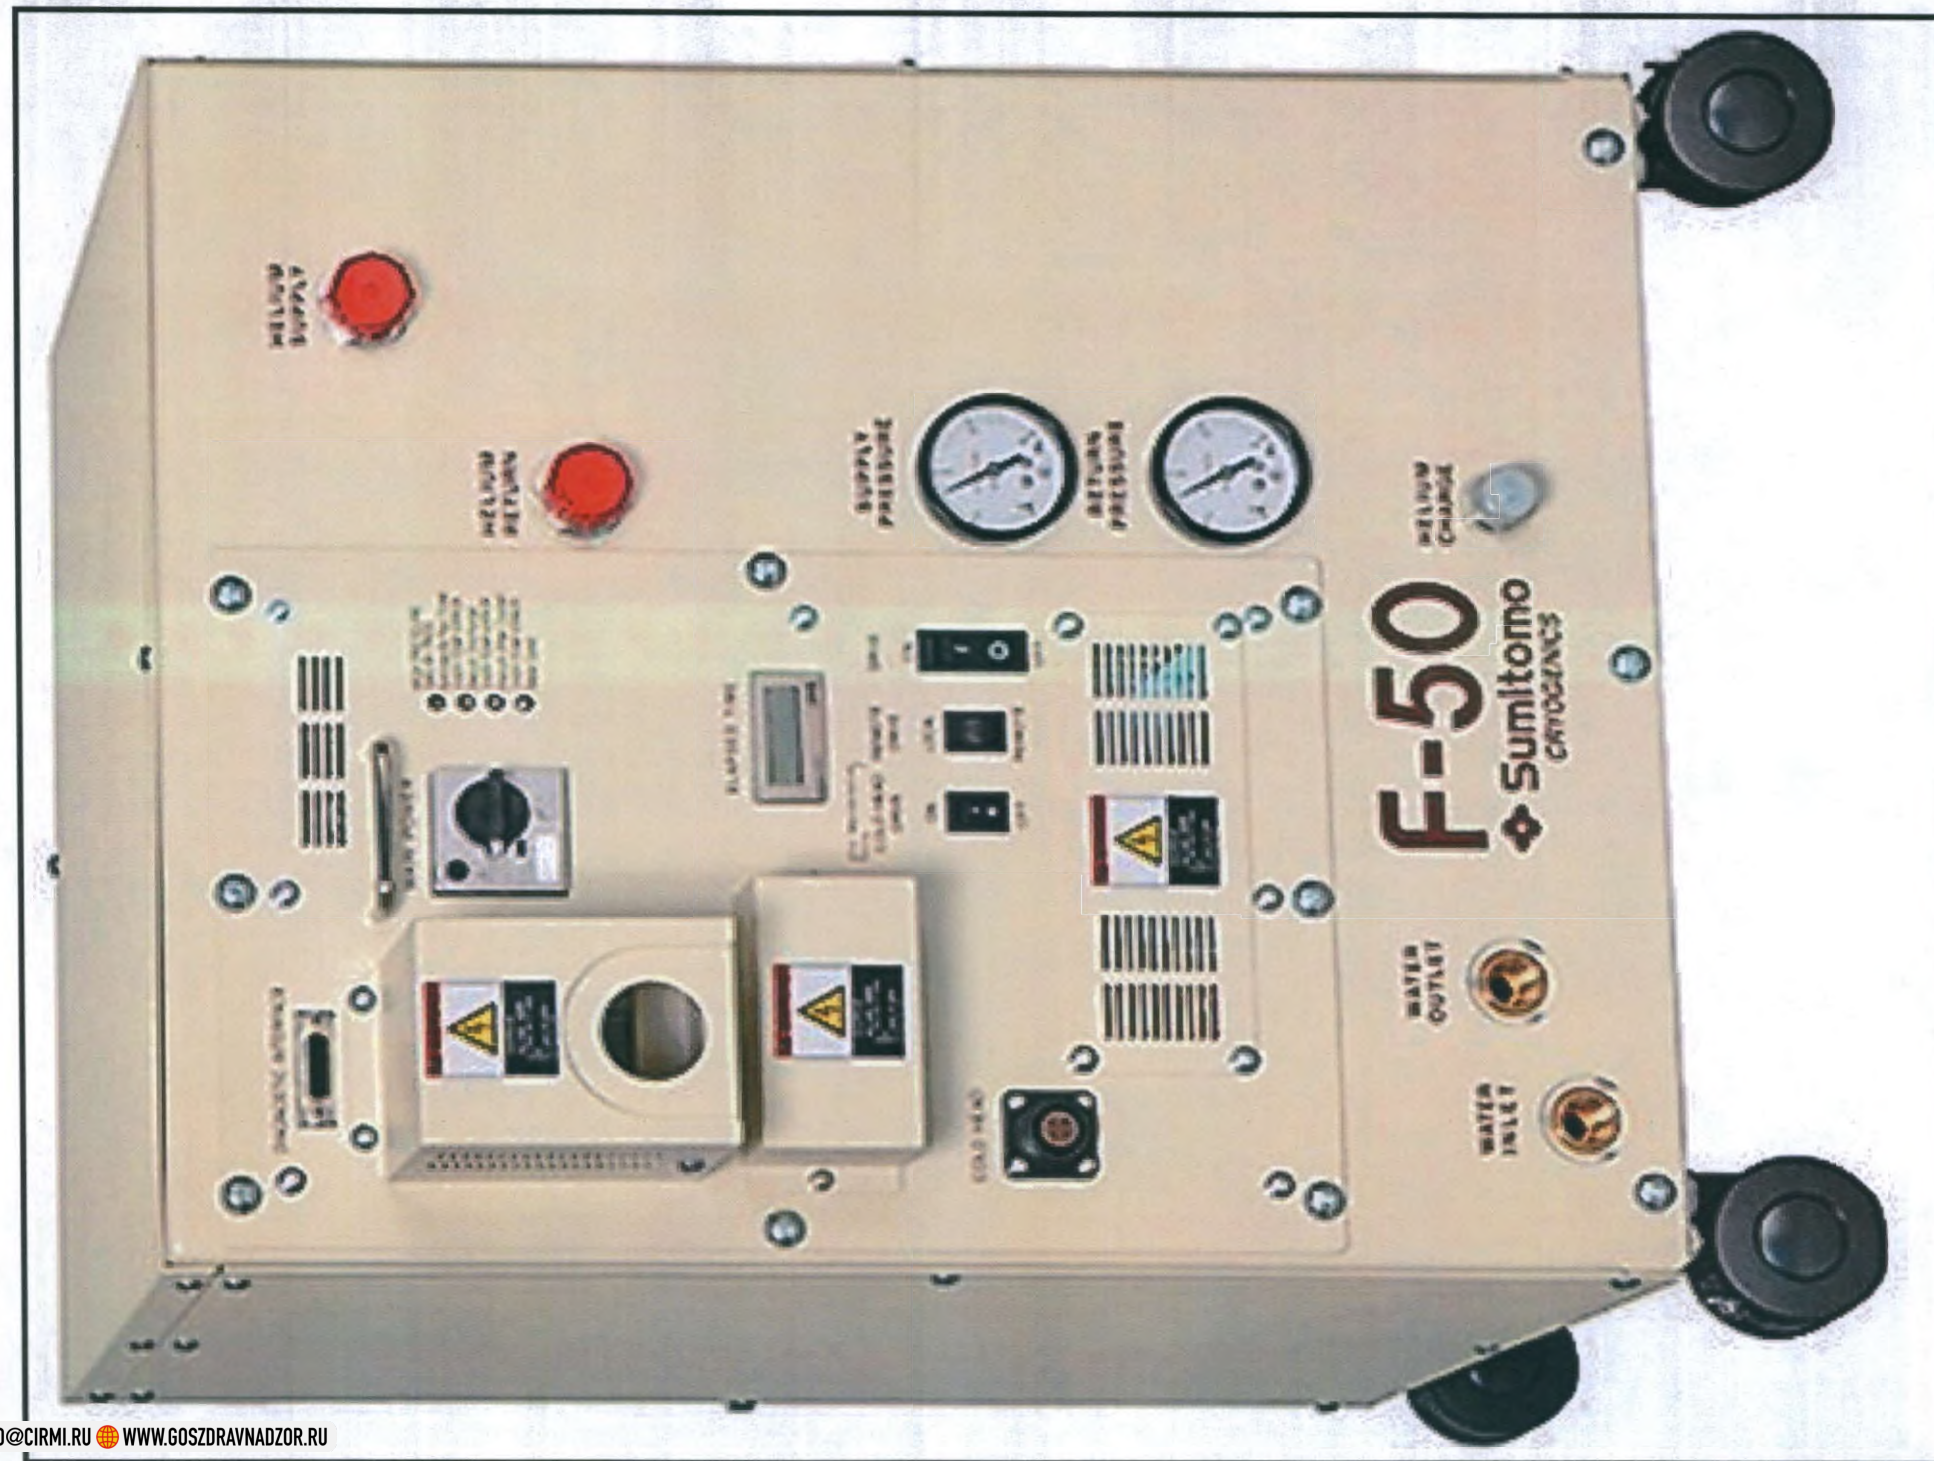







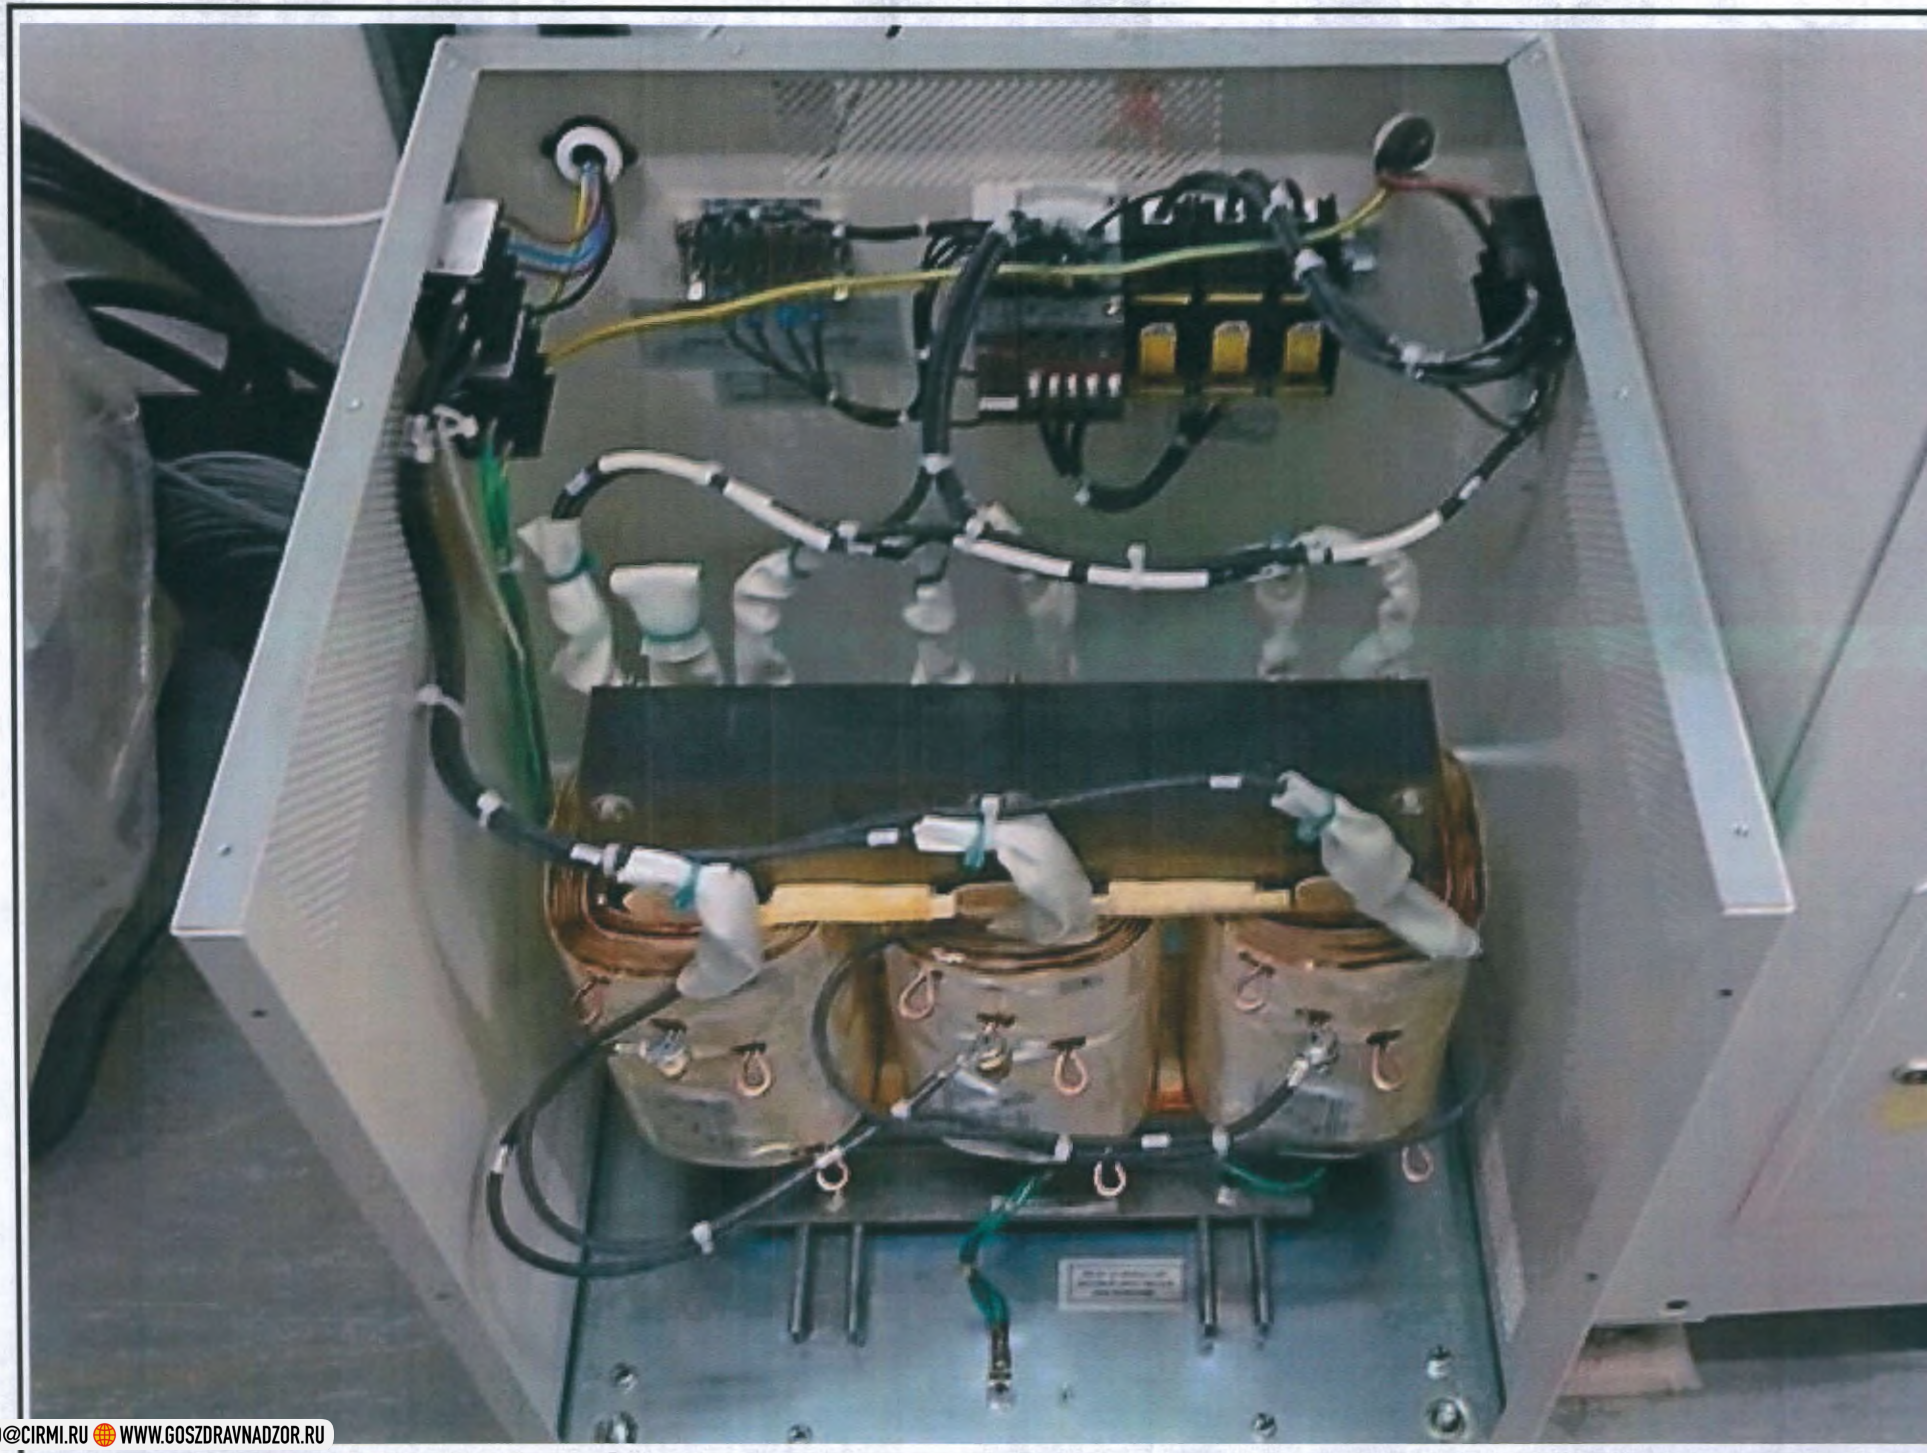

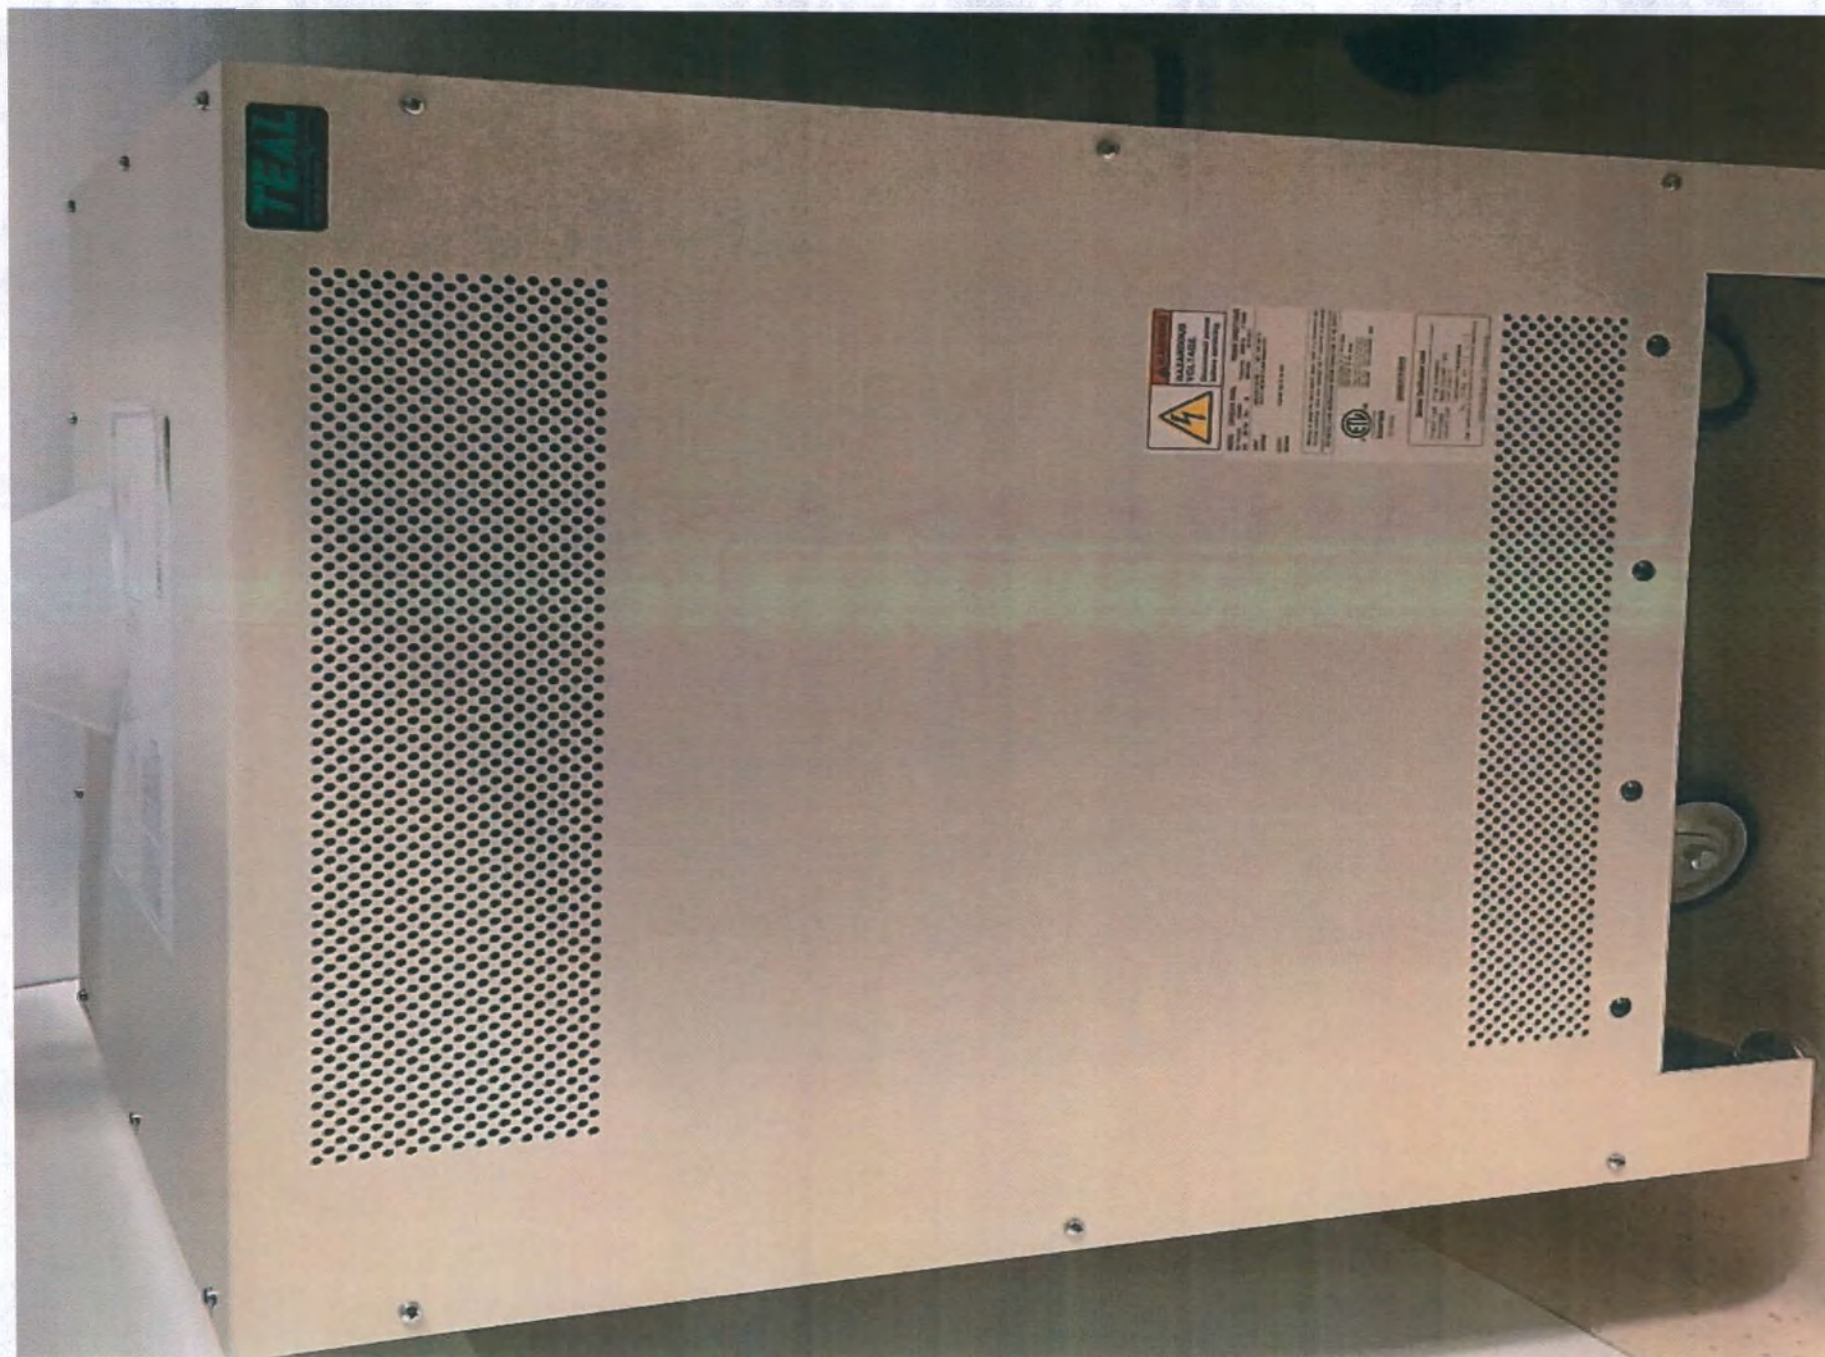




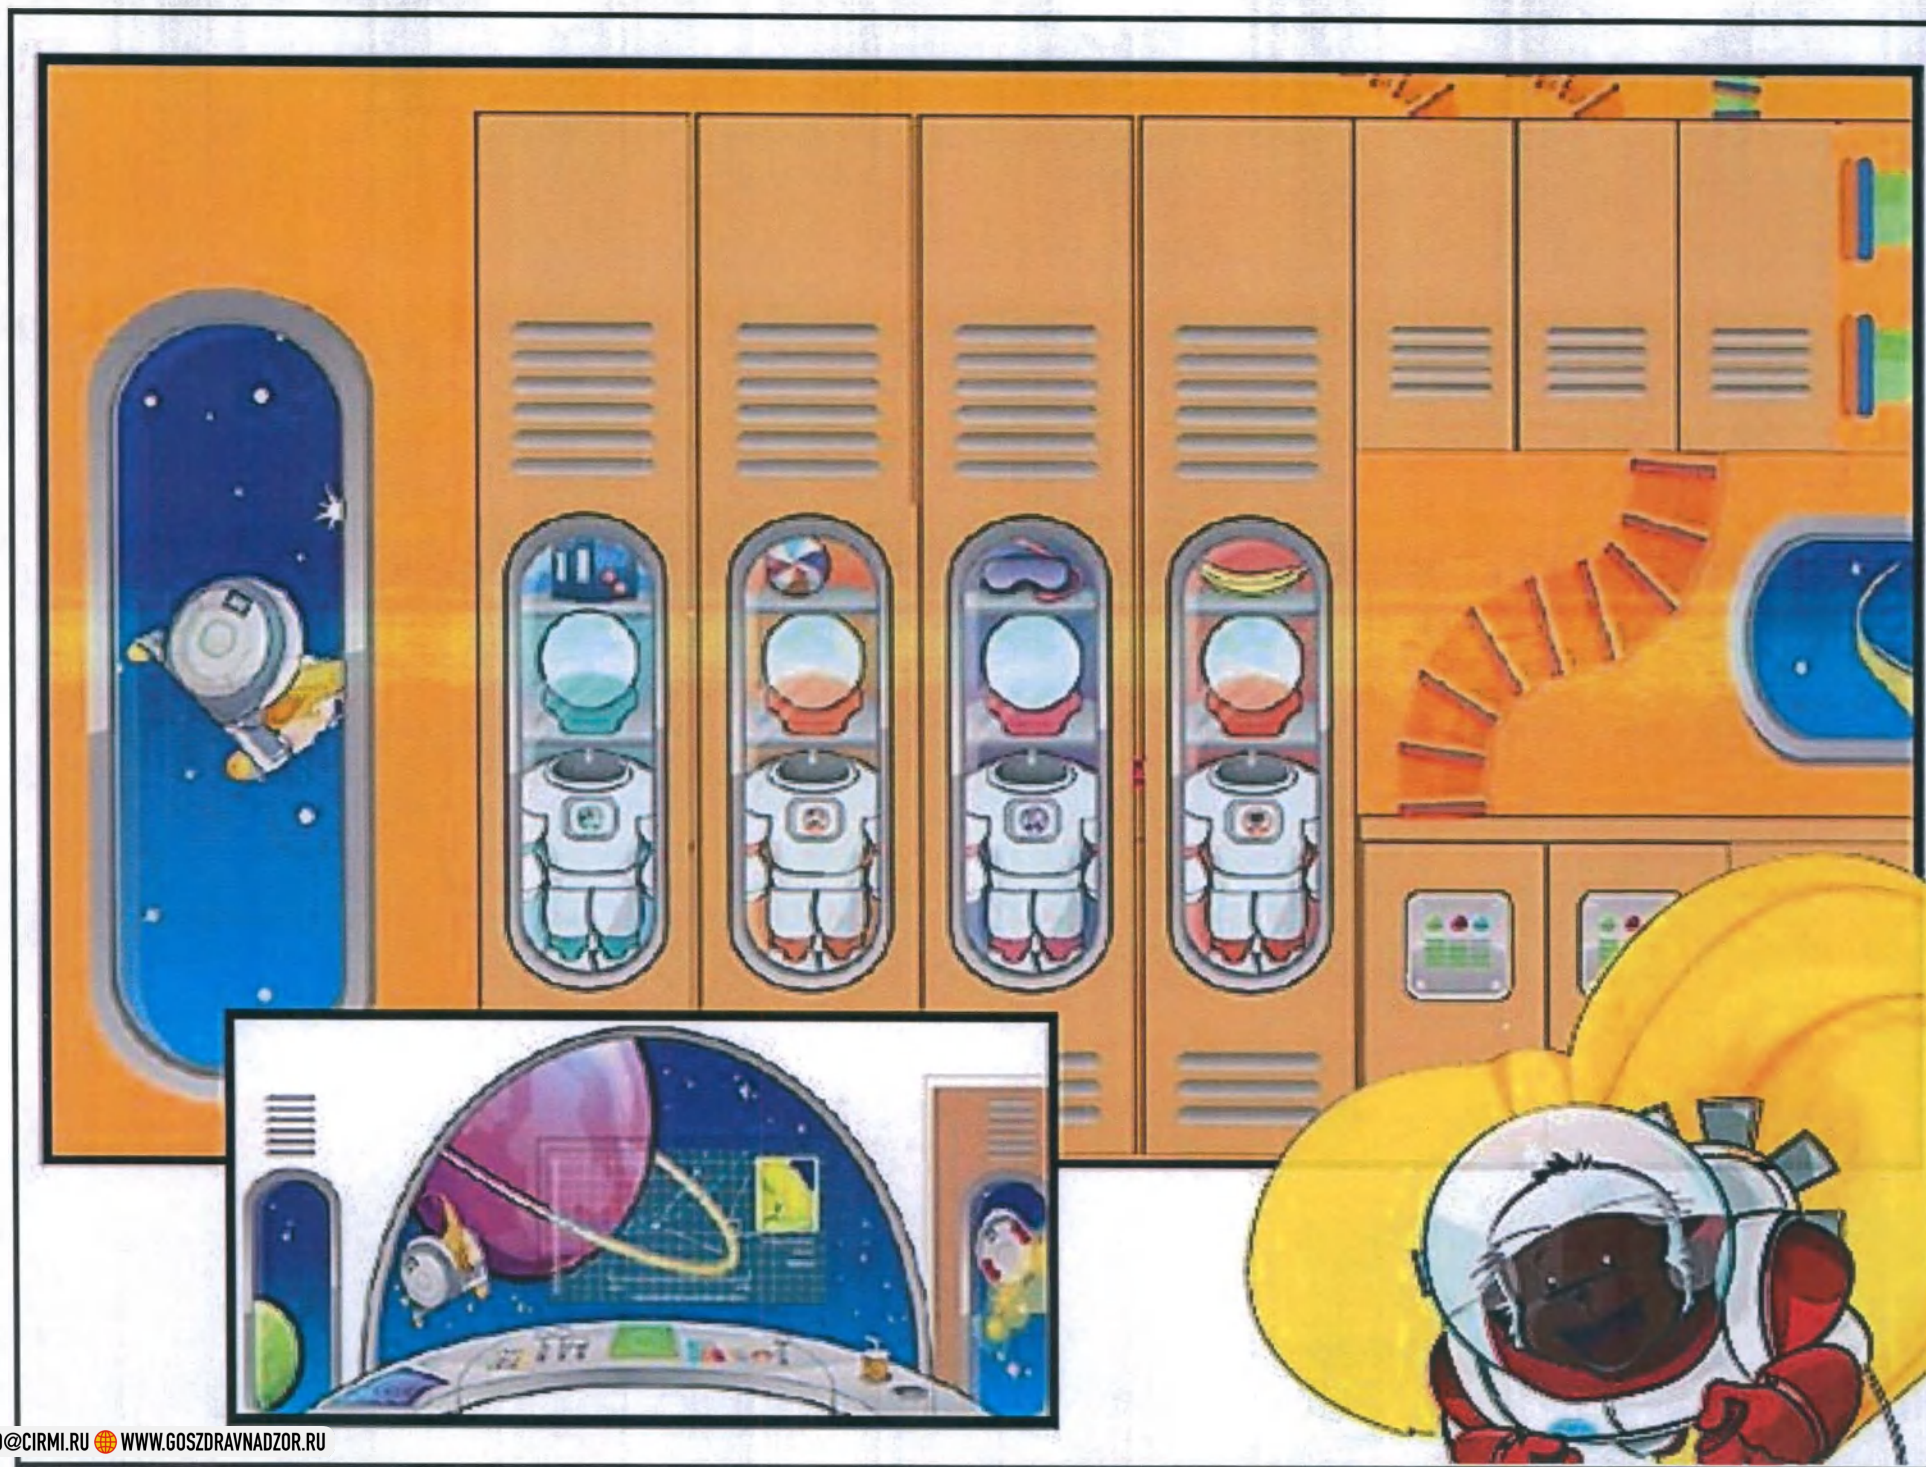

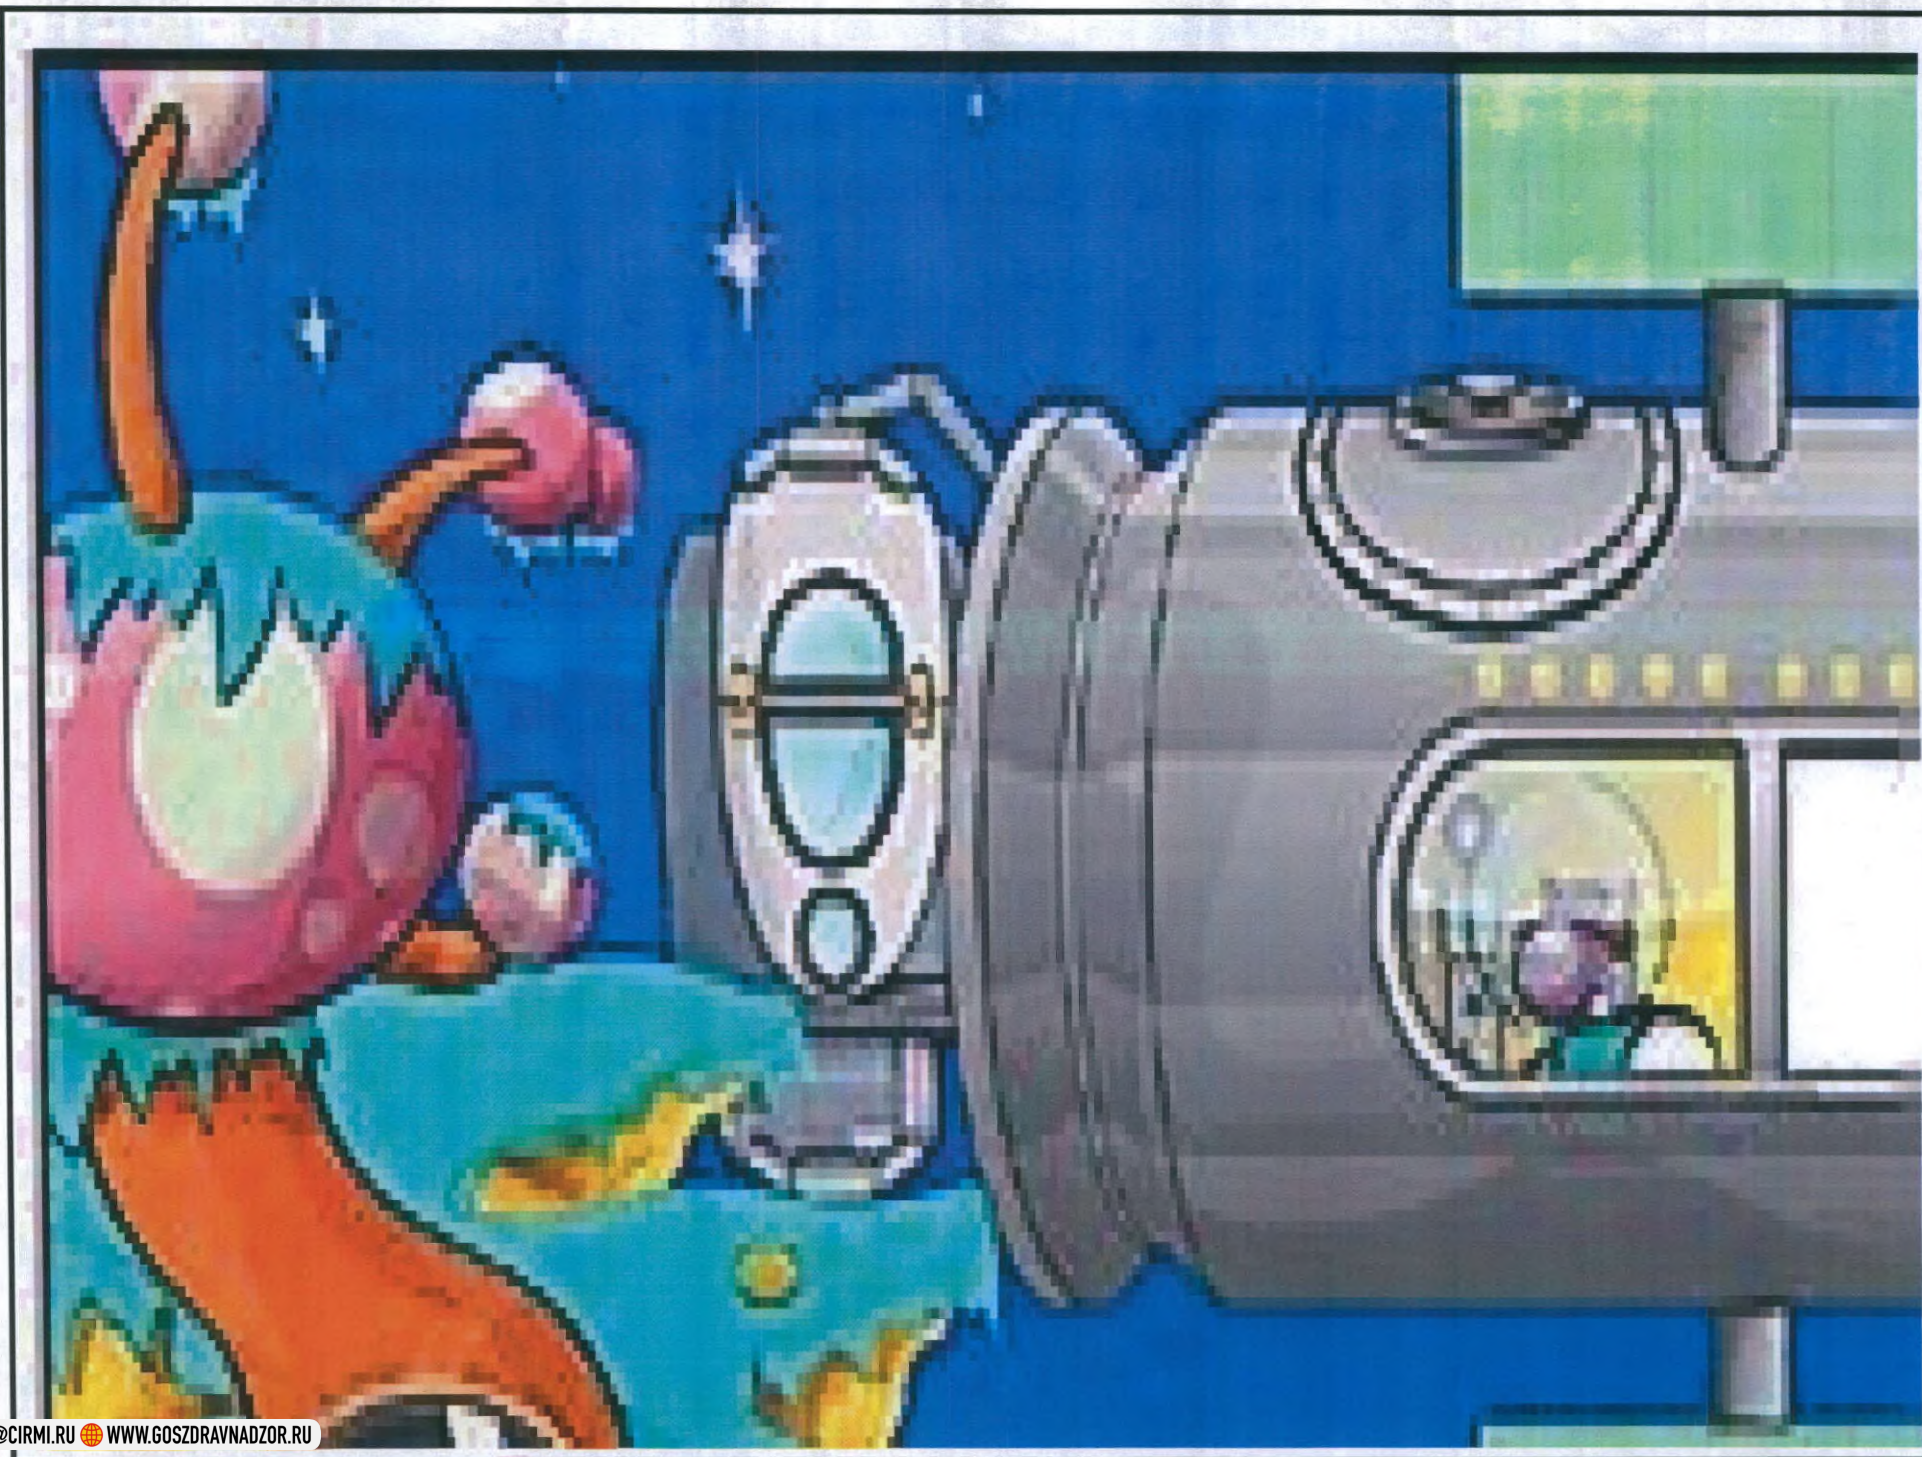


58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

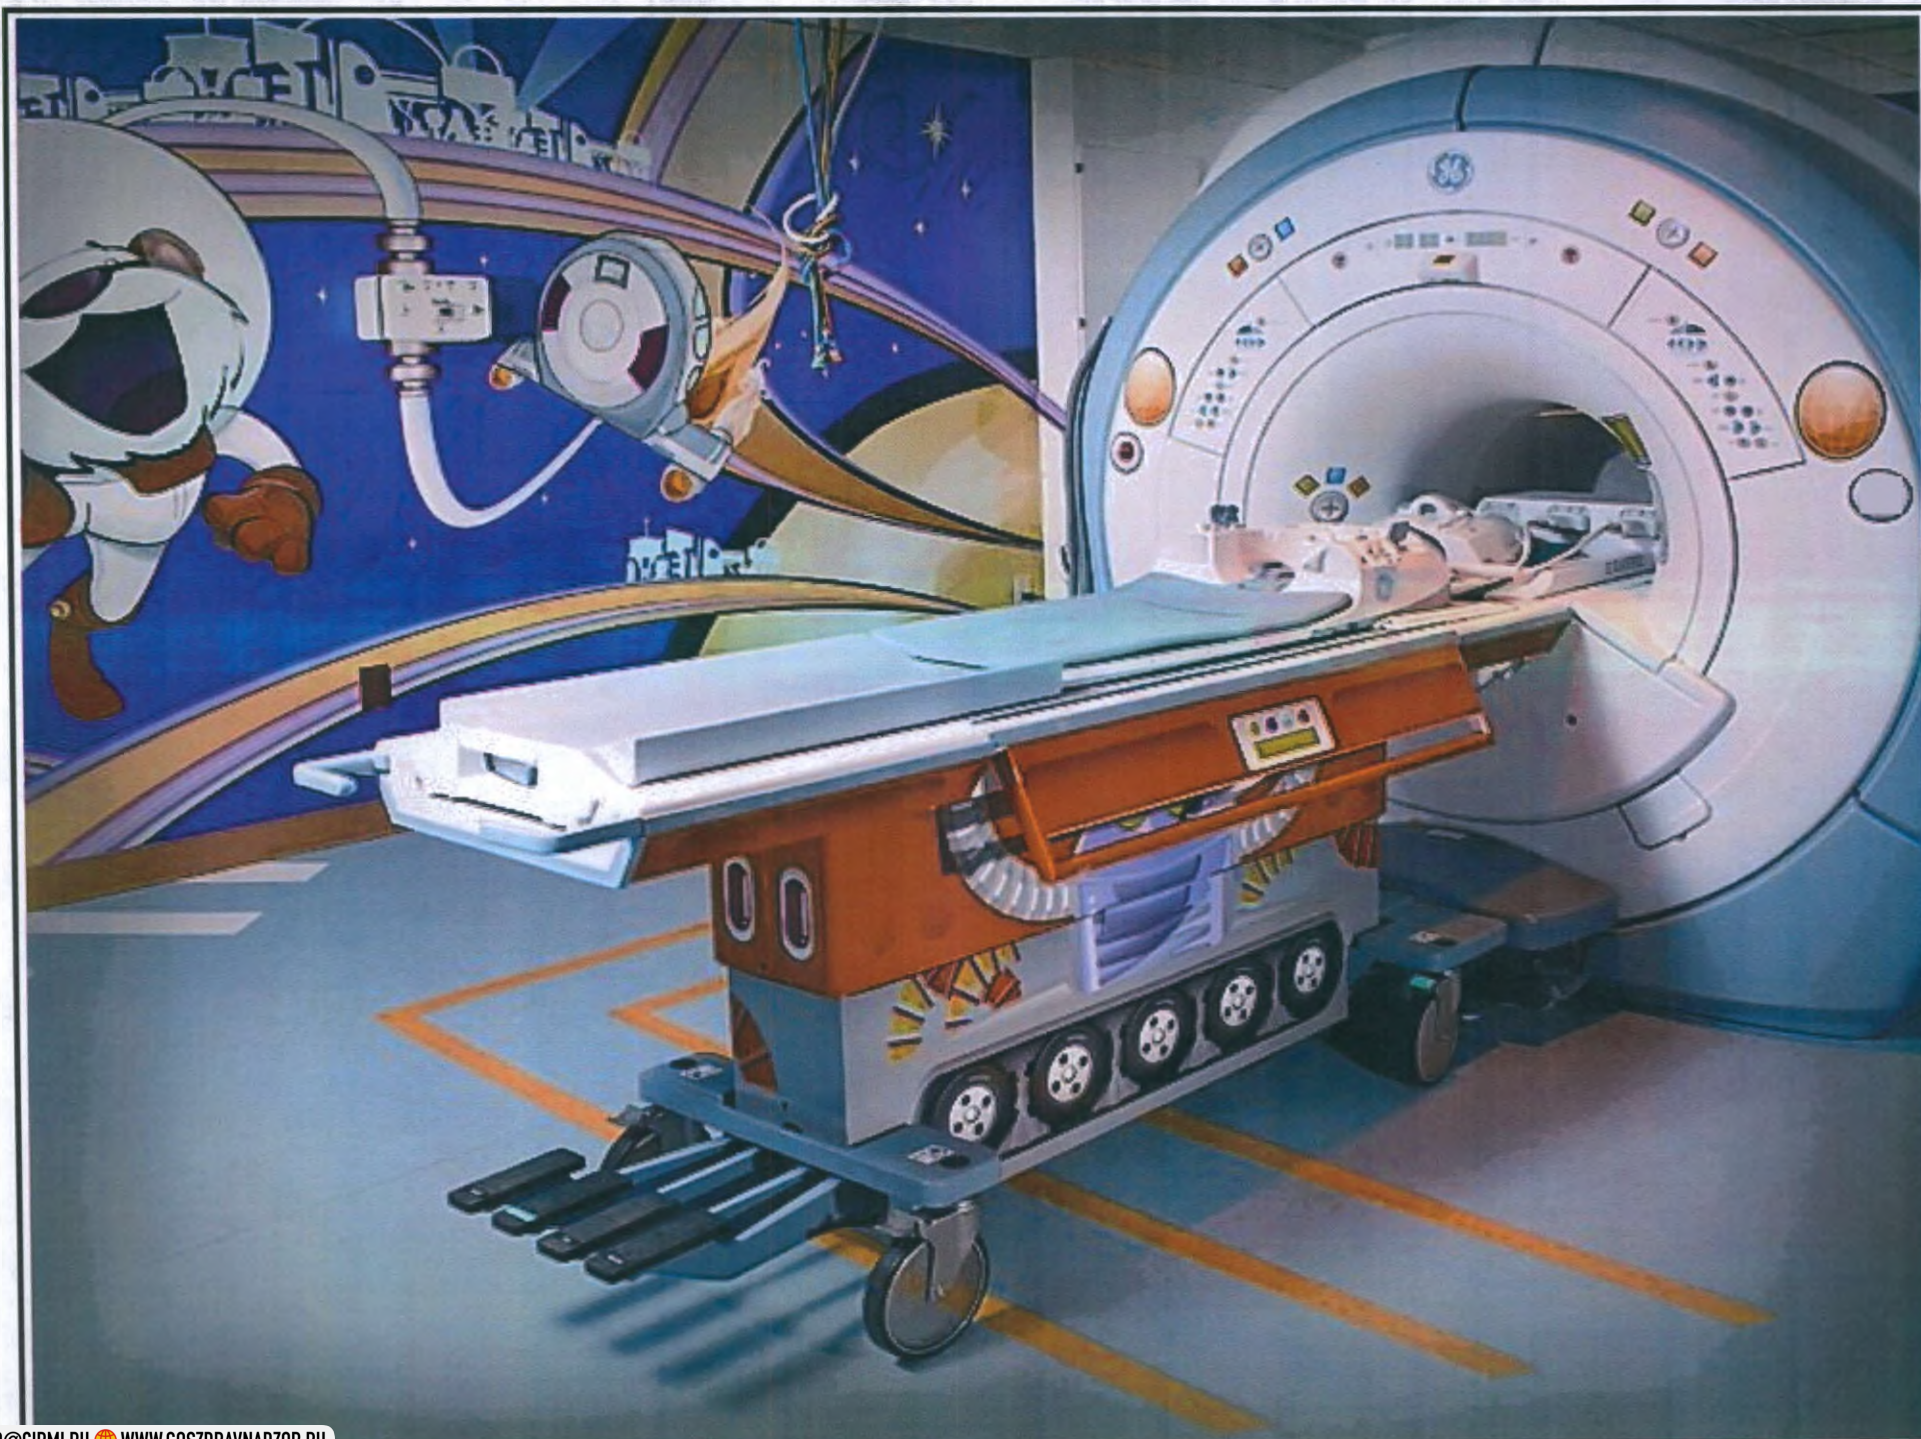


58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).



58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

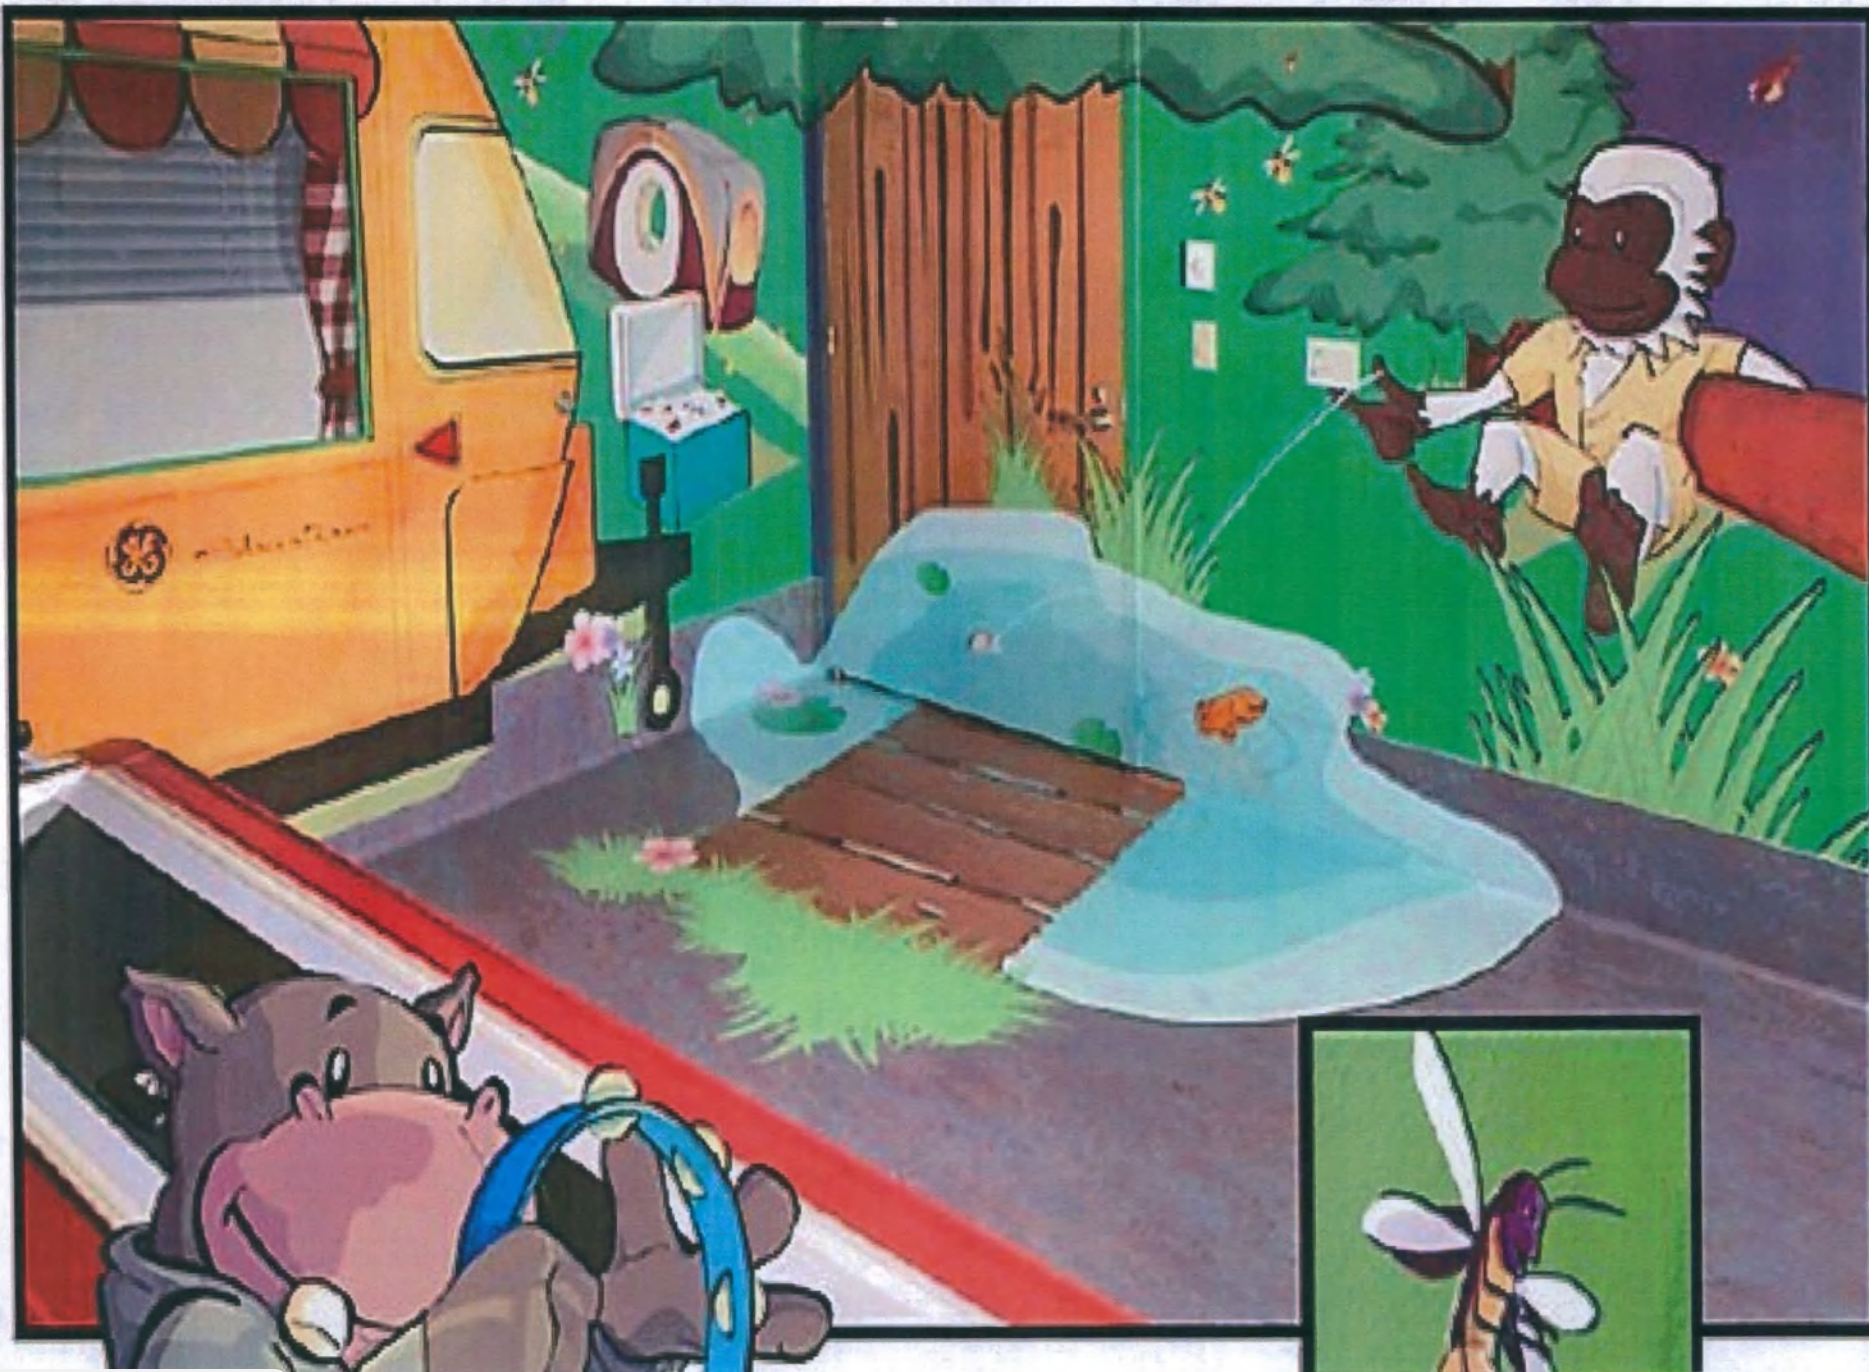

58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

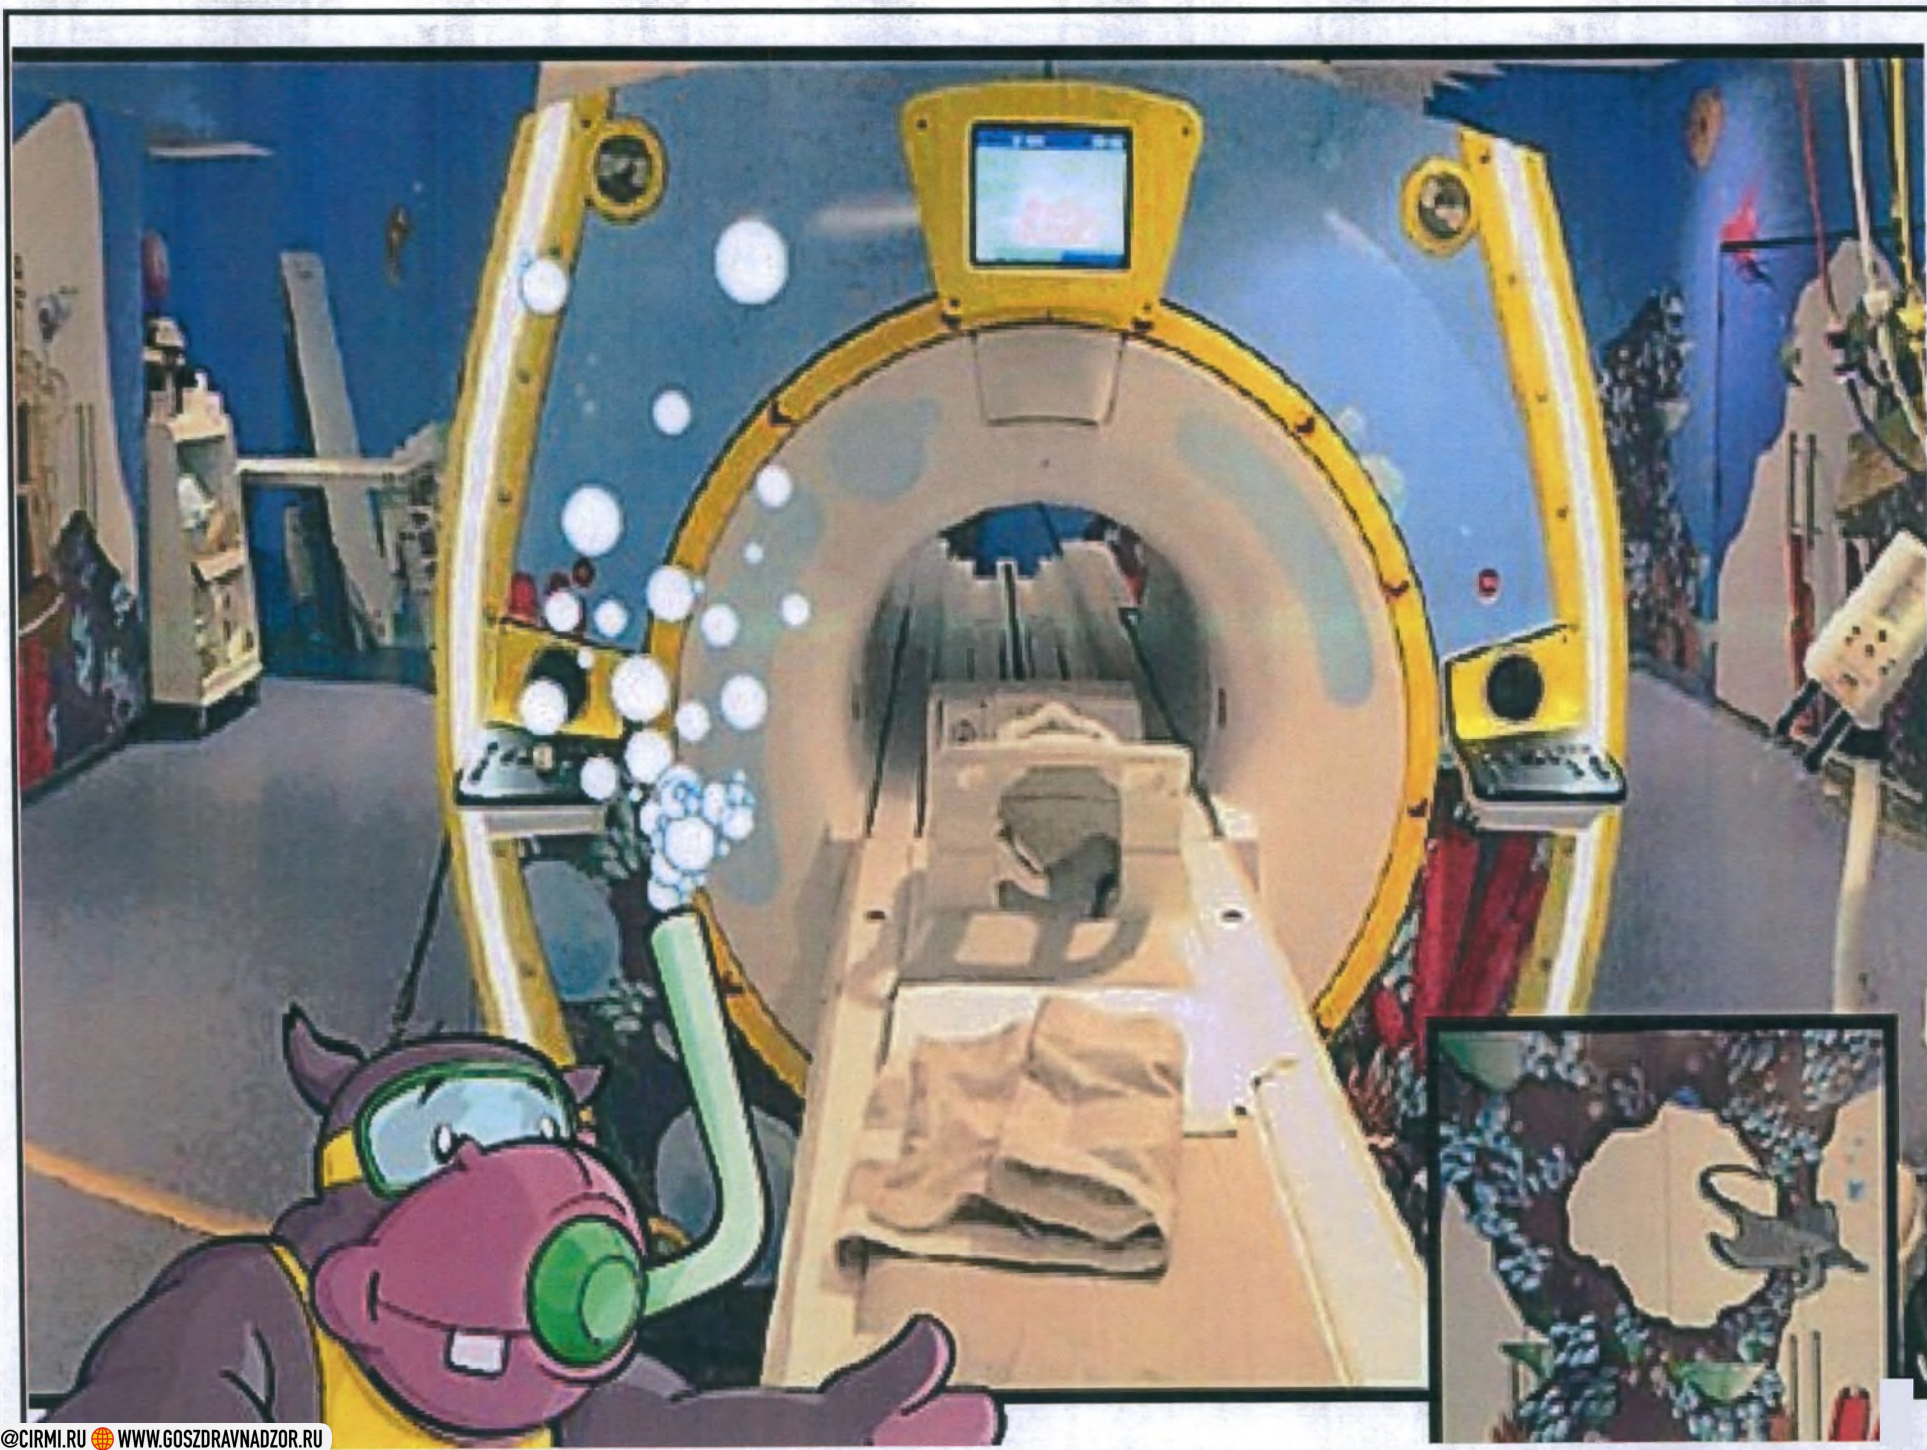


58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).




59. Блок обдува (не более 10 шт.)



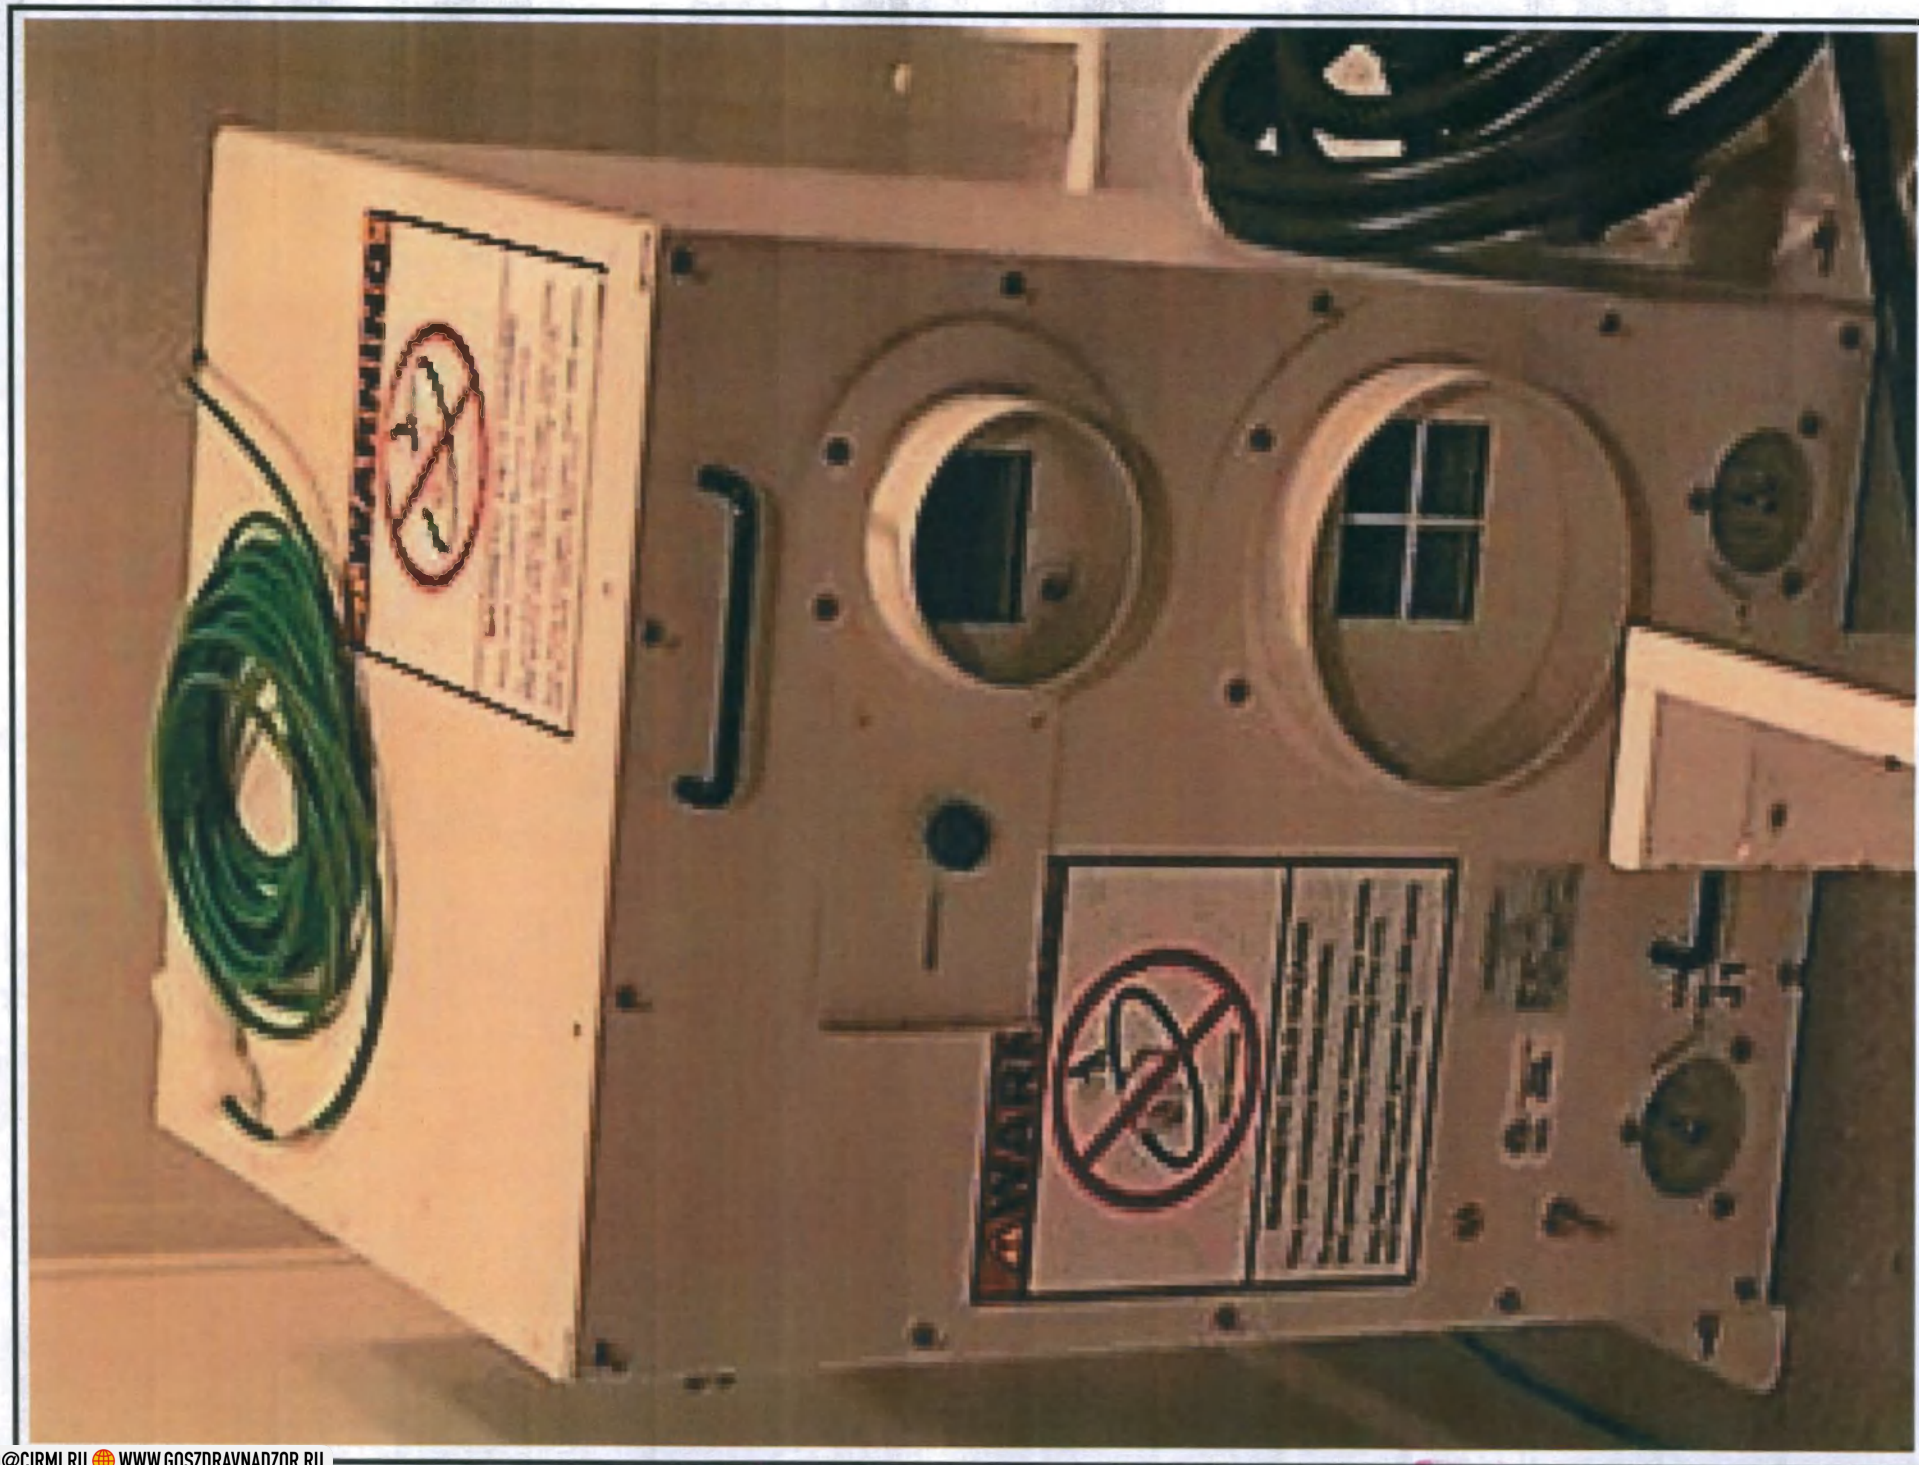

59. Блок обдува (не более 10 шт.)

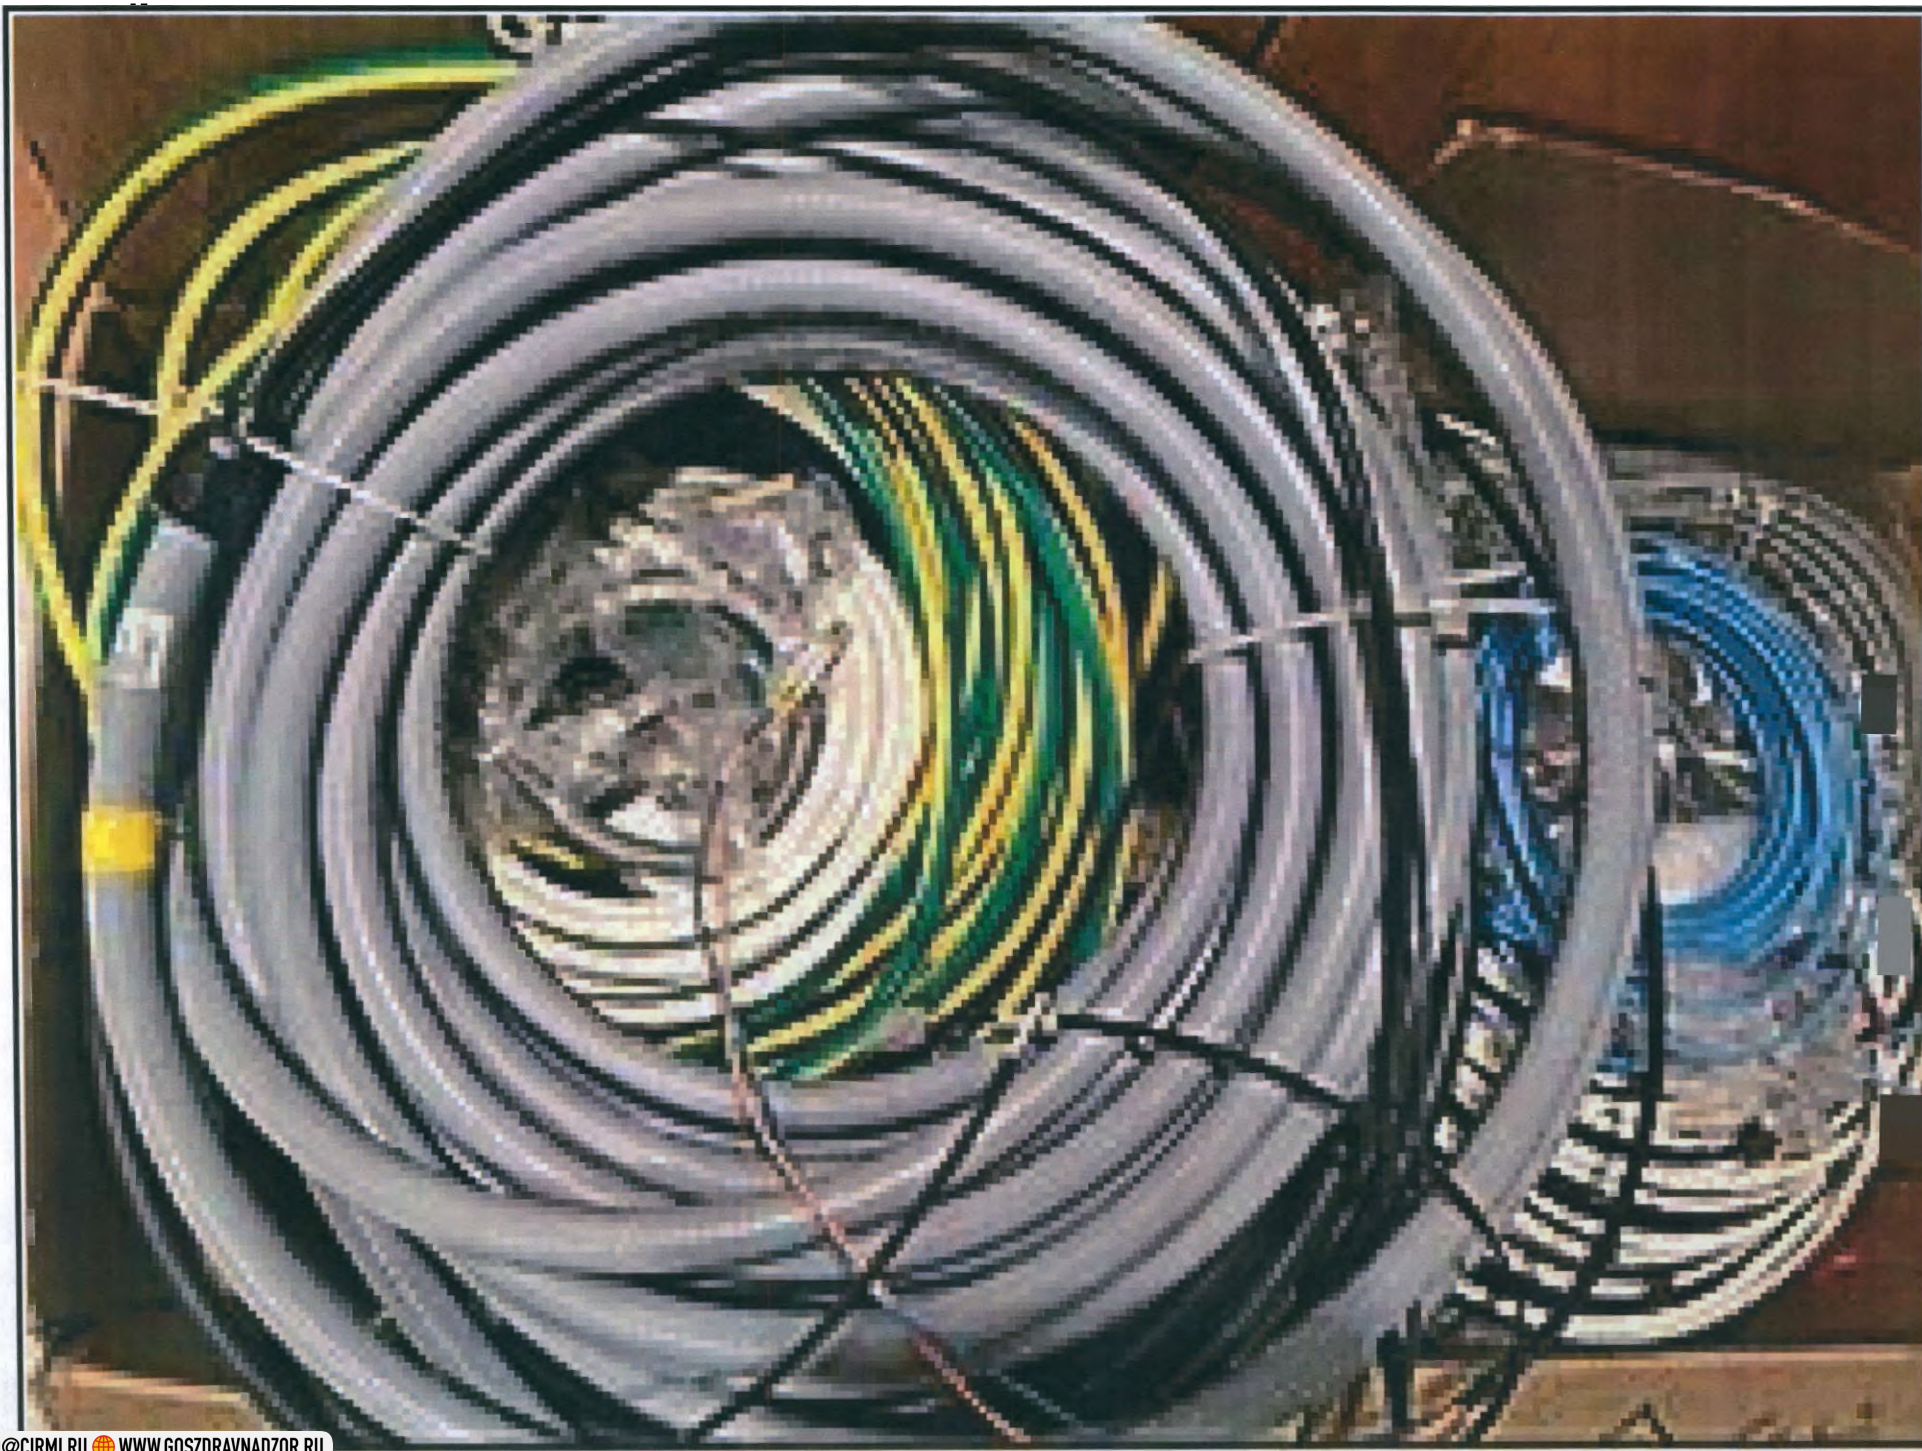

60. Модуль памяти.





61. Адаптеры для круглых катушек общего назначения (не более 5 шт.).



61. Адаптеры для круглых катушек общего назначения (не более 5 шт.).



62. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).




62. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).




62. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).



63. Монитор магнитный (не более 5 шт.).

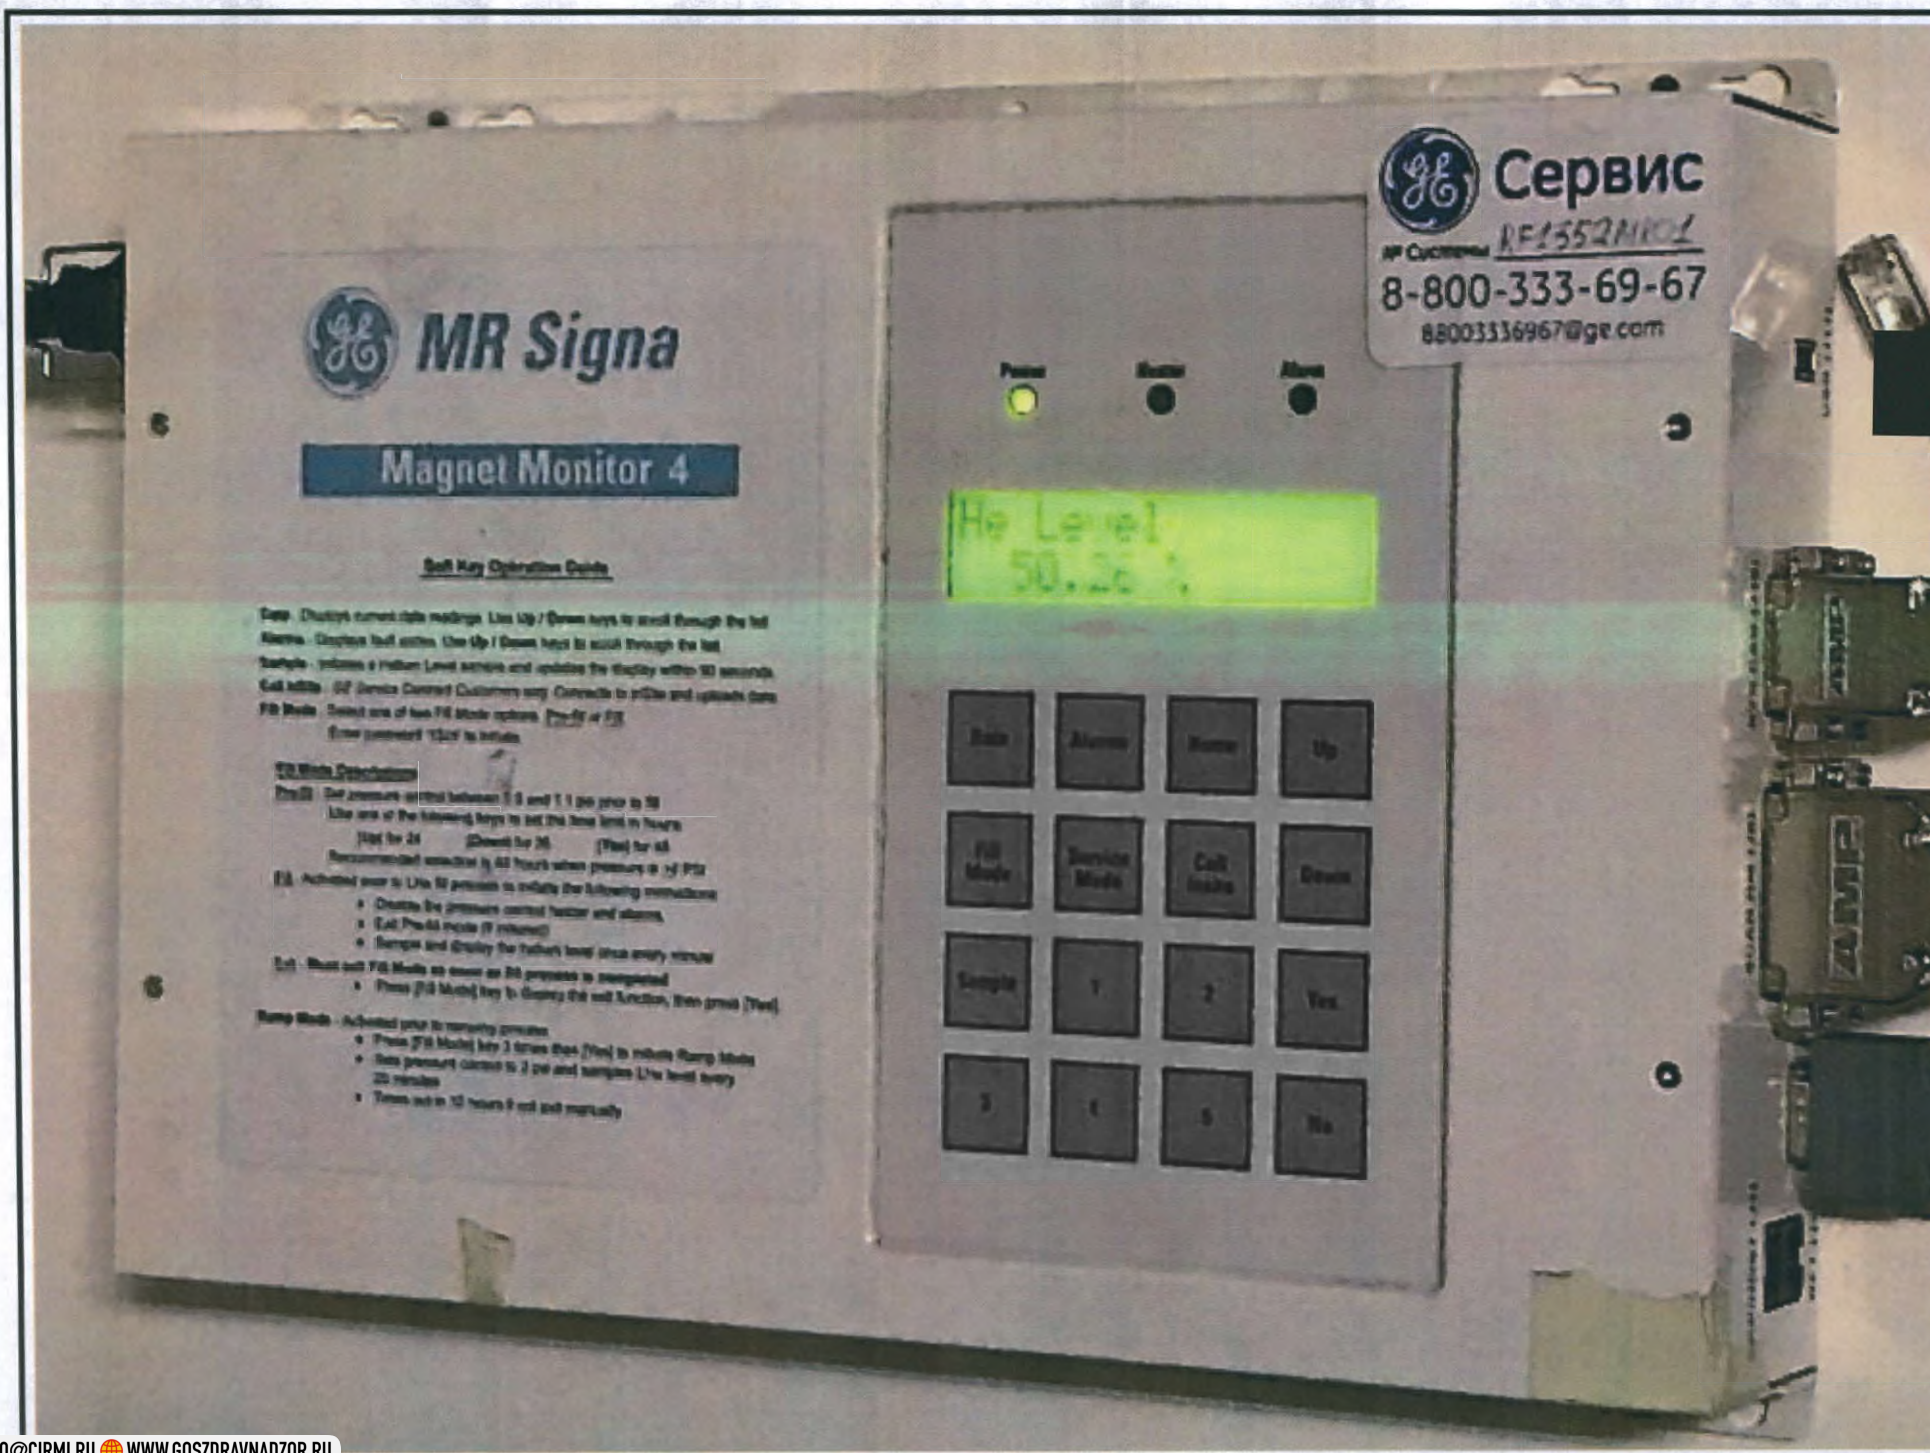

64. Блок управления сигнальной системы для пациента.

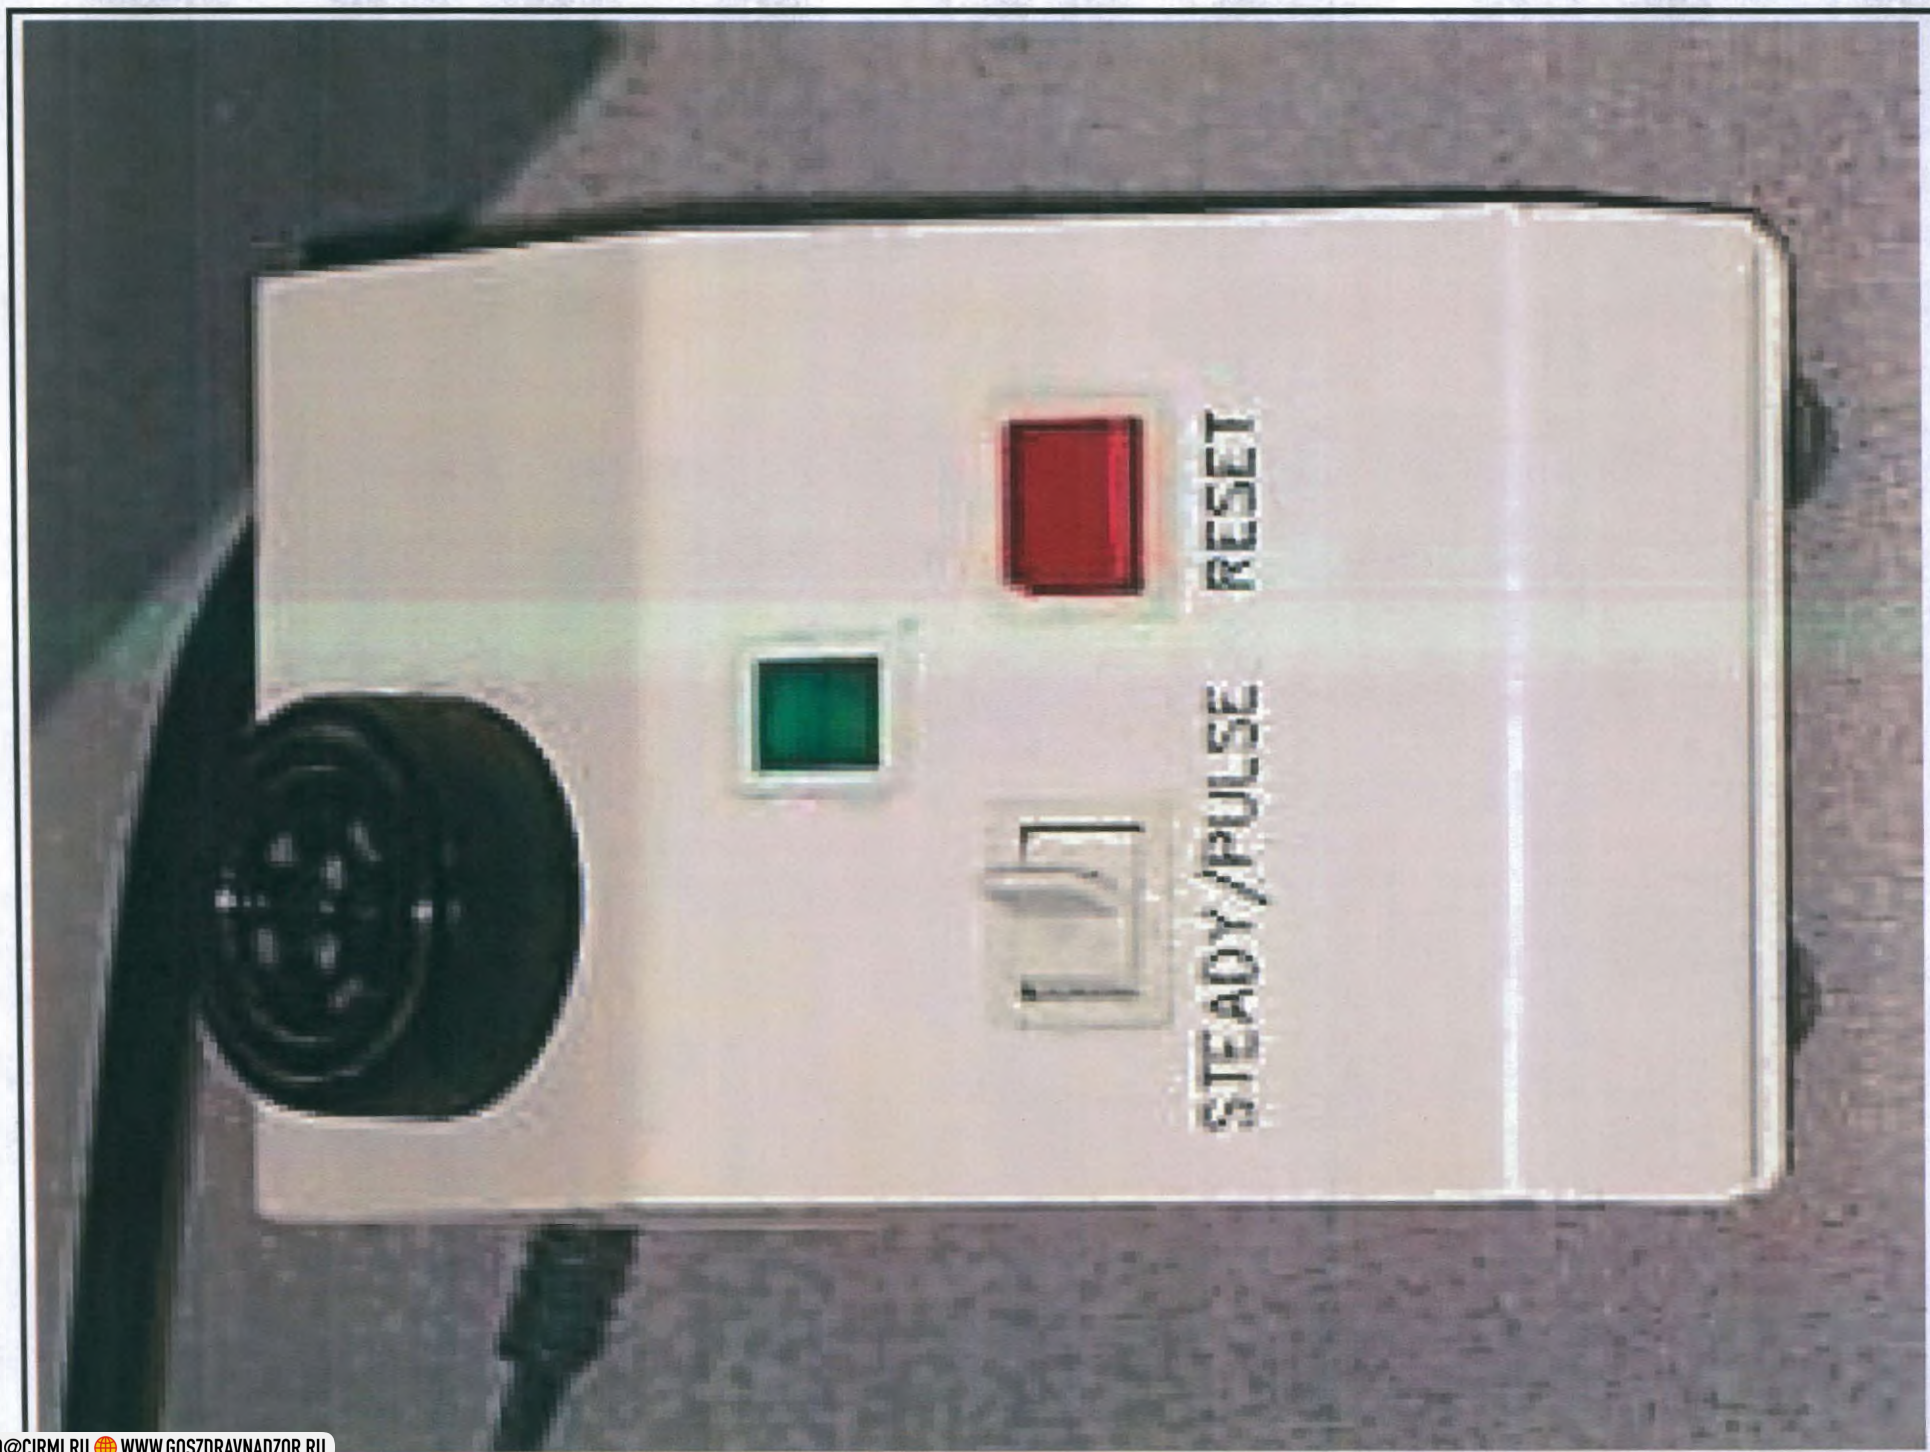



64. Блок управления сигнальной системы для пациента.



64. Блок управления сигнальной системы для пациента.



ПРОШТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬ *289* ЛИСТА(ОВ)

Ахметов

