

Фотографические изображения
медицинского изделия

**Томограф магнитно-резонансный *SIGNA Voyager*
с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации и
сертификации России и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А.П. Харитонов А.П. Харитонов

30 июля 2021г

Производства

«ДжиИ Хэлскеа (Тяньцзинь) Компани Лимитед»,
Китай

GE Healthcare (Tianjin) Company Limited



GE Healthcare (Tianjin) Company LTD
No.266 Jingsan Road, Tianjin Airport
Economic Area, Tianjin, 300308 P.R. China



REF

SIGNA Voyager

SN

380/400/415 V3~, 50/60 Hz

480 V3~, 60 Hz

≤ 64 kVA_{cont}, ≤ 77 kVA_{mom}



YYYY-MM

CE 0459





GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED
NO.266 JINGSAN ROAD, TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308

REF

SIGNA Voyager

EC

REP

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC FRANCE

SN



YYYY-MM

MD



0197

Rx ONLY

380/400/415 V3~, 50/60 Hz
480 V3~, 60 Hz
≤ 64 kVAcont, ≤ 77 kVA mom





GE Healthcare (Tianjin) Company LTD

No.266 Jingsan Road, Tianjin Airport

Economic Area, Tianjin, 300308 P.R. China



GE Medical Systems, LLC

3001 West Radio Drive

Florence, SC 29501 USA

REF

SIGNA Voyager

SN

380/400/415 V3~, 50/60 Hz

480 V3~, 60 Hz

≤ 64 kVA_{cont}, ≤ 77 kVA_{nom}



YYYY-MM



 **GE HEALTHCARE (TIANJIN) COMPANY LIMITED**
NO.266 JINGSAN ROAD, TIANJIN AIRPORT ECONOMIC AREA
TIANJIN, P.R. CHINA 300308

 **GE HEALTHCARE MANUFACTURING LLC**
3001 WEST RADIO DRIVE, FLORENCE, SC 29501 USA

REF **SIGNA Voyager**

EC **REP**

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIERE
78530 BUC FRANCE

SN

 **YYYY-MM**

MD

C **E** **0197**

R_x ONLY

380/400/415 V3~, 50/60 Hz
480 V3~, 60 Hz
≤ 64 kVAcont, ≤ 77 kVAmom



Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации»
для GE Healthcare (Tianjin) Company Limited

Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager

REF

XXXXXXXXXXXXX

SN

XXXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX

EAC




380 / 400 / 415 В 3 ~, 50 Гц
≤ 64 кВА (длительная мощность),
≤ 77 кВА (кратковременная мощность)


Сделано в России

XXXXXXXX


I. Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager :

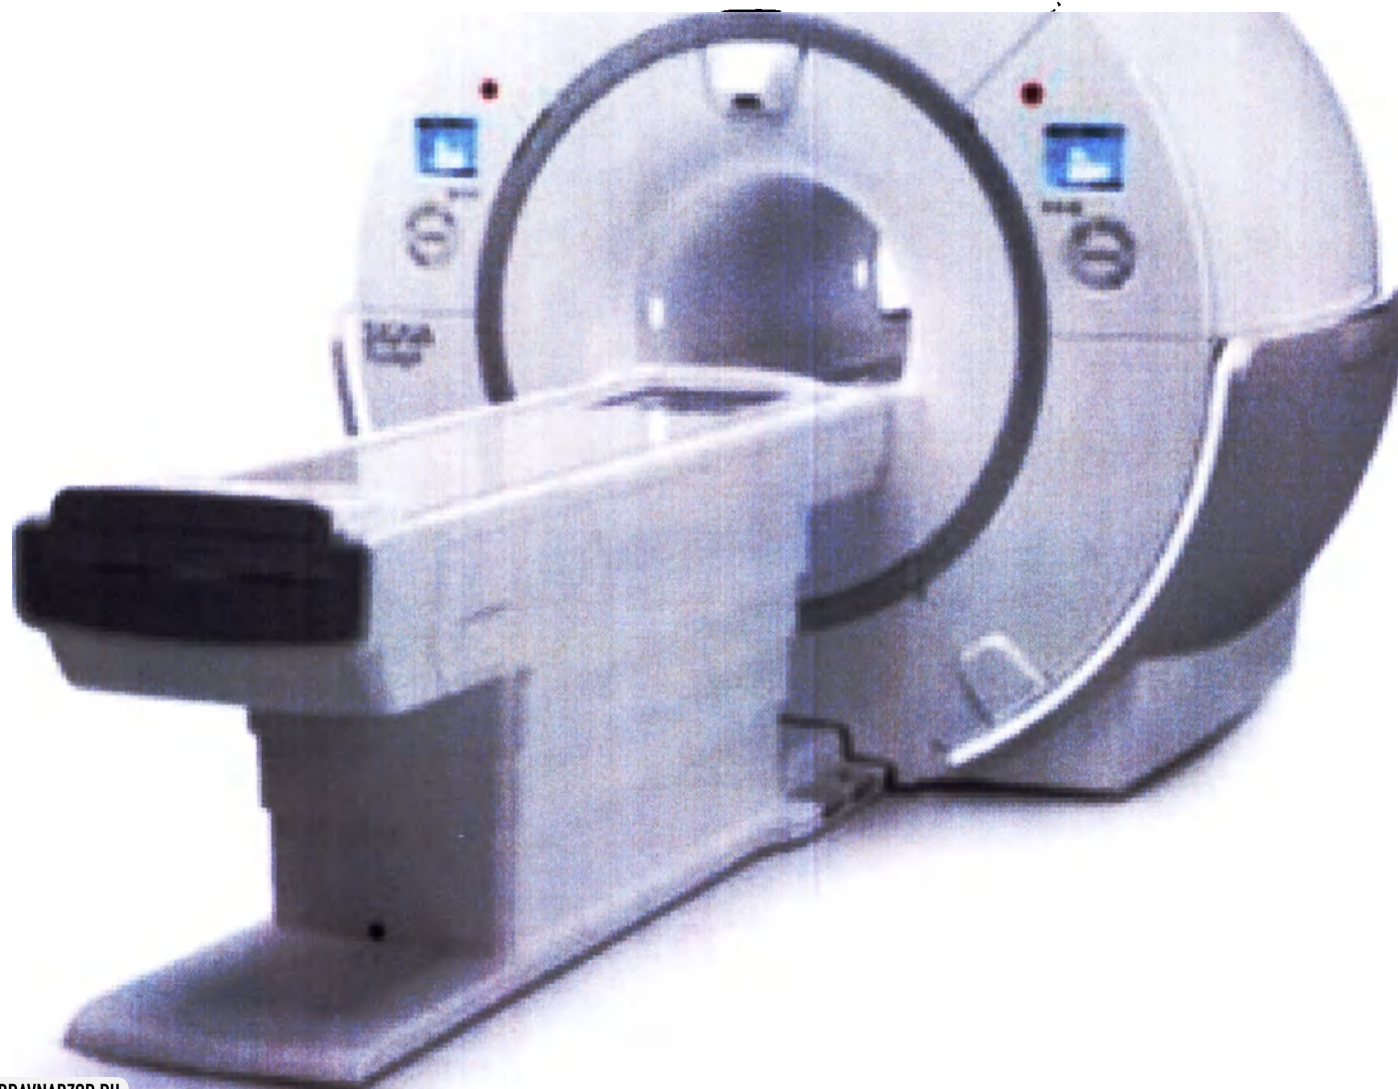


1.Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой, варианты исполнения: LCCw, IPM.

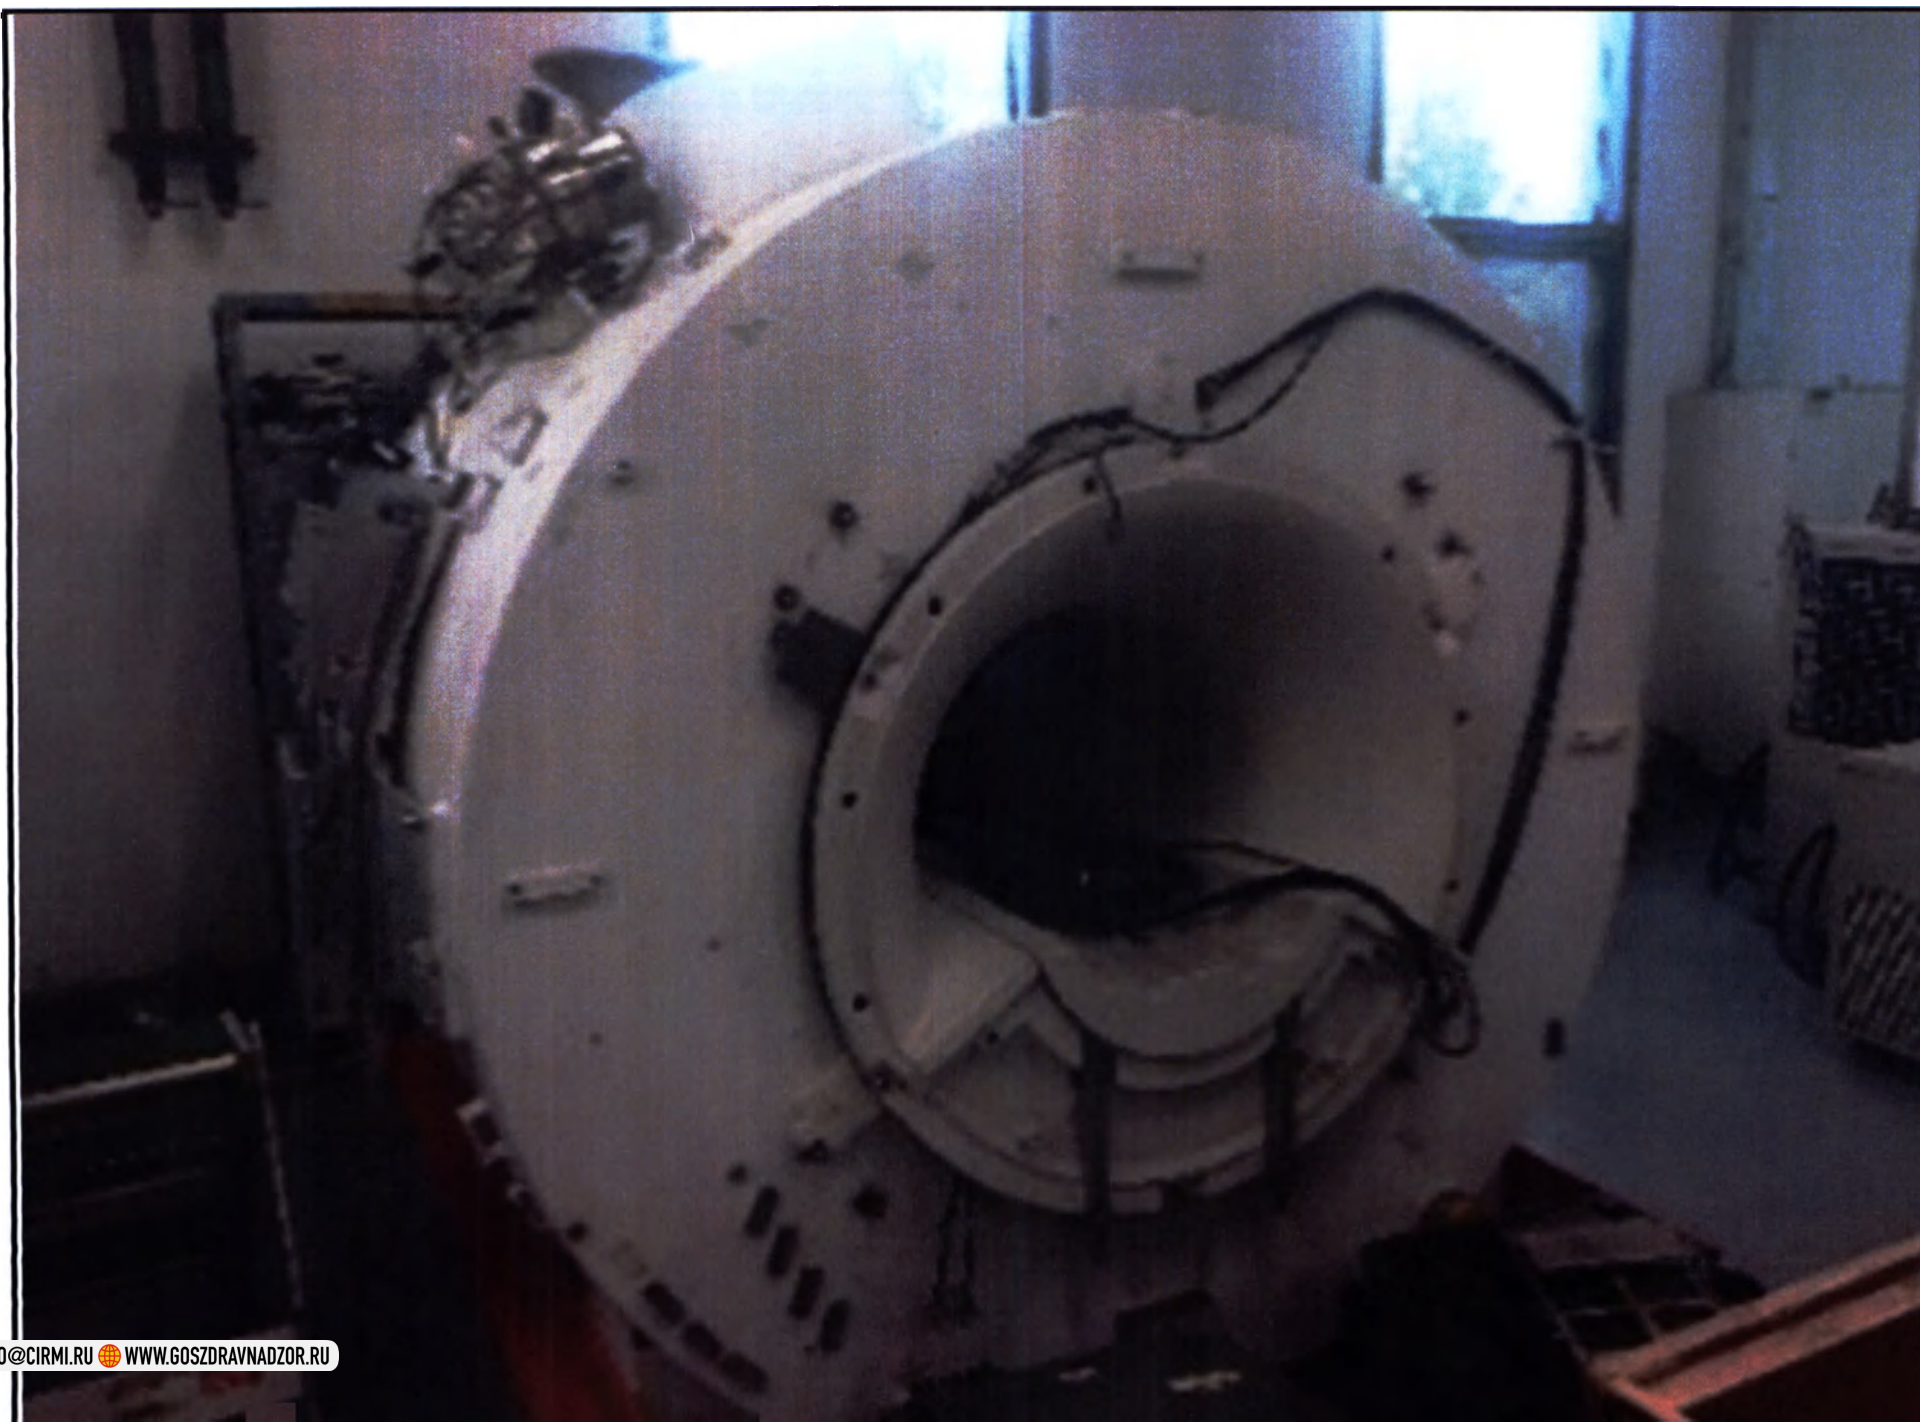


1.Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой, варианты исполнения: LCCw, IPM.

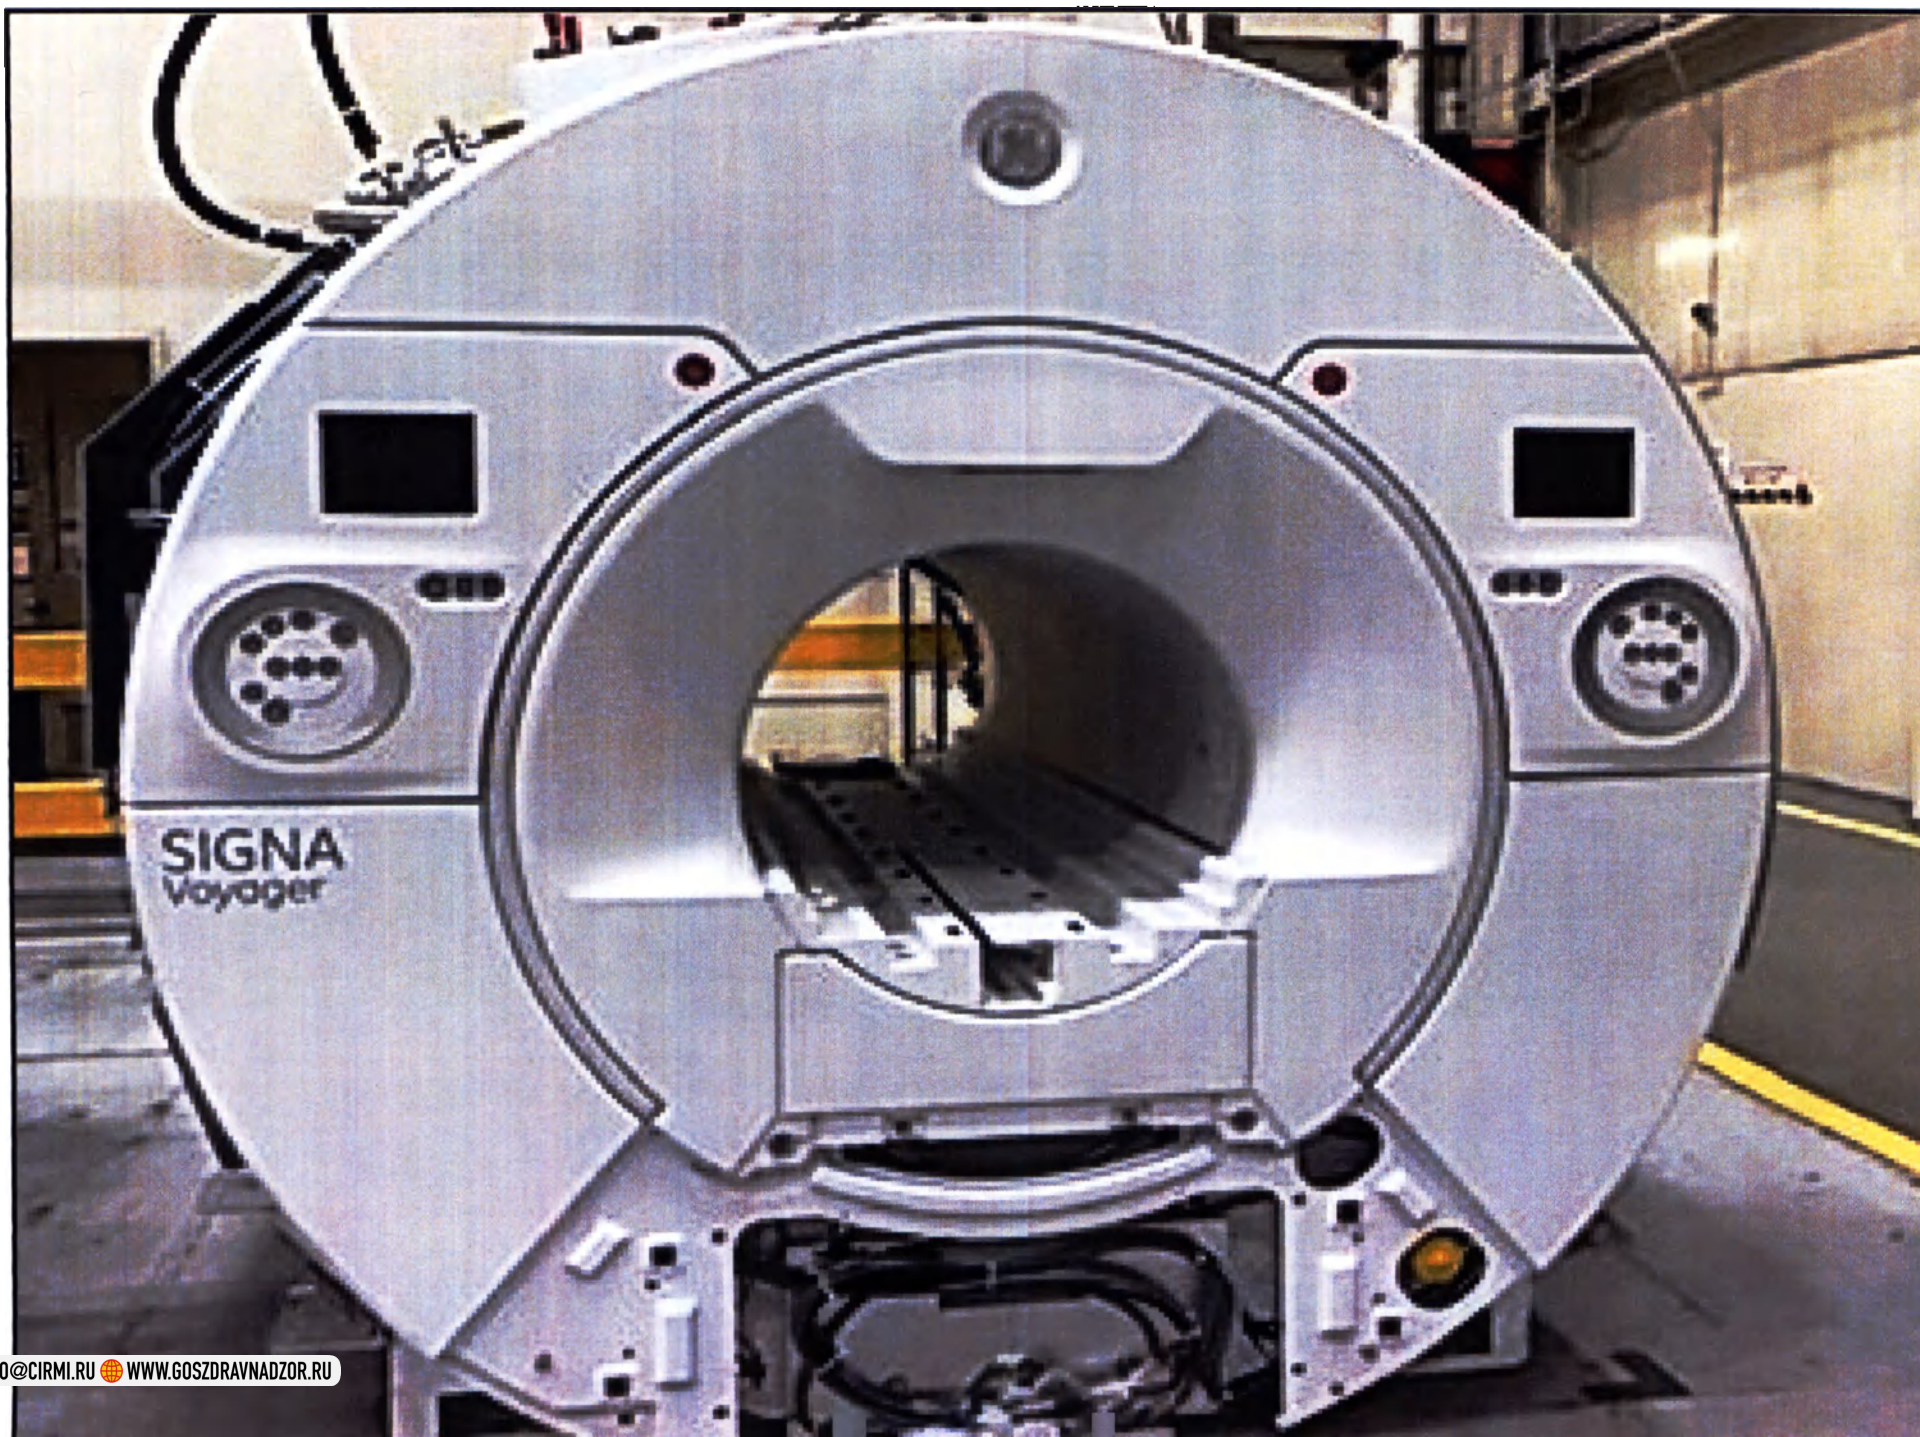

1.Магнит с активным экранированием и встроенной РЧ-катушкой, варианты исполнения: LCCw, IPM.

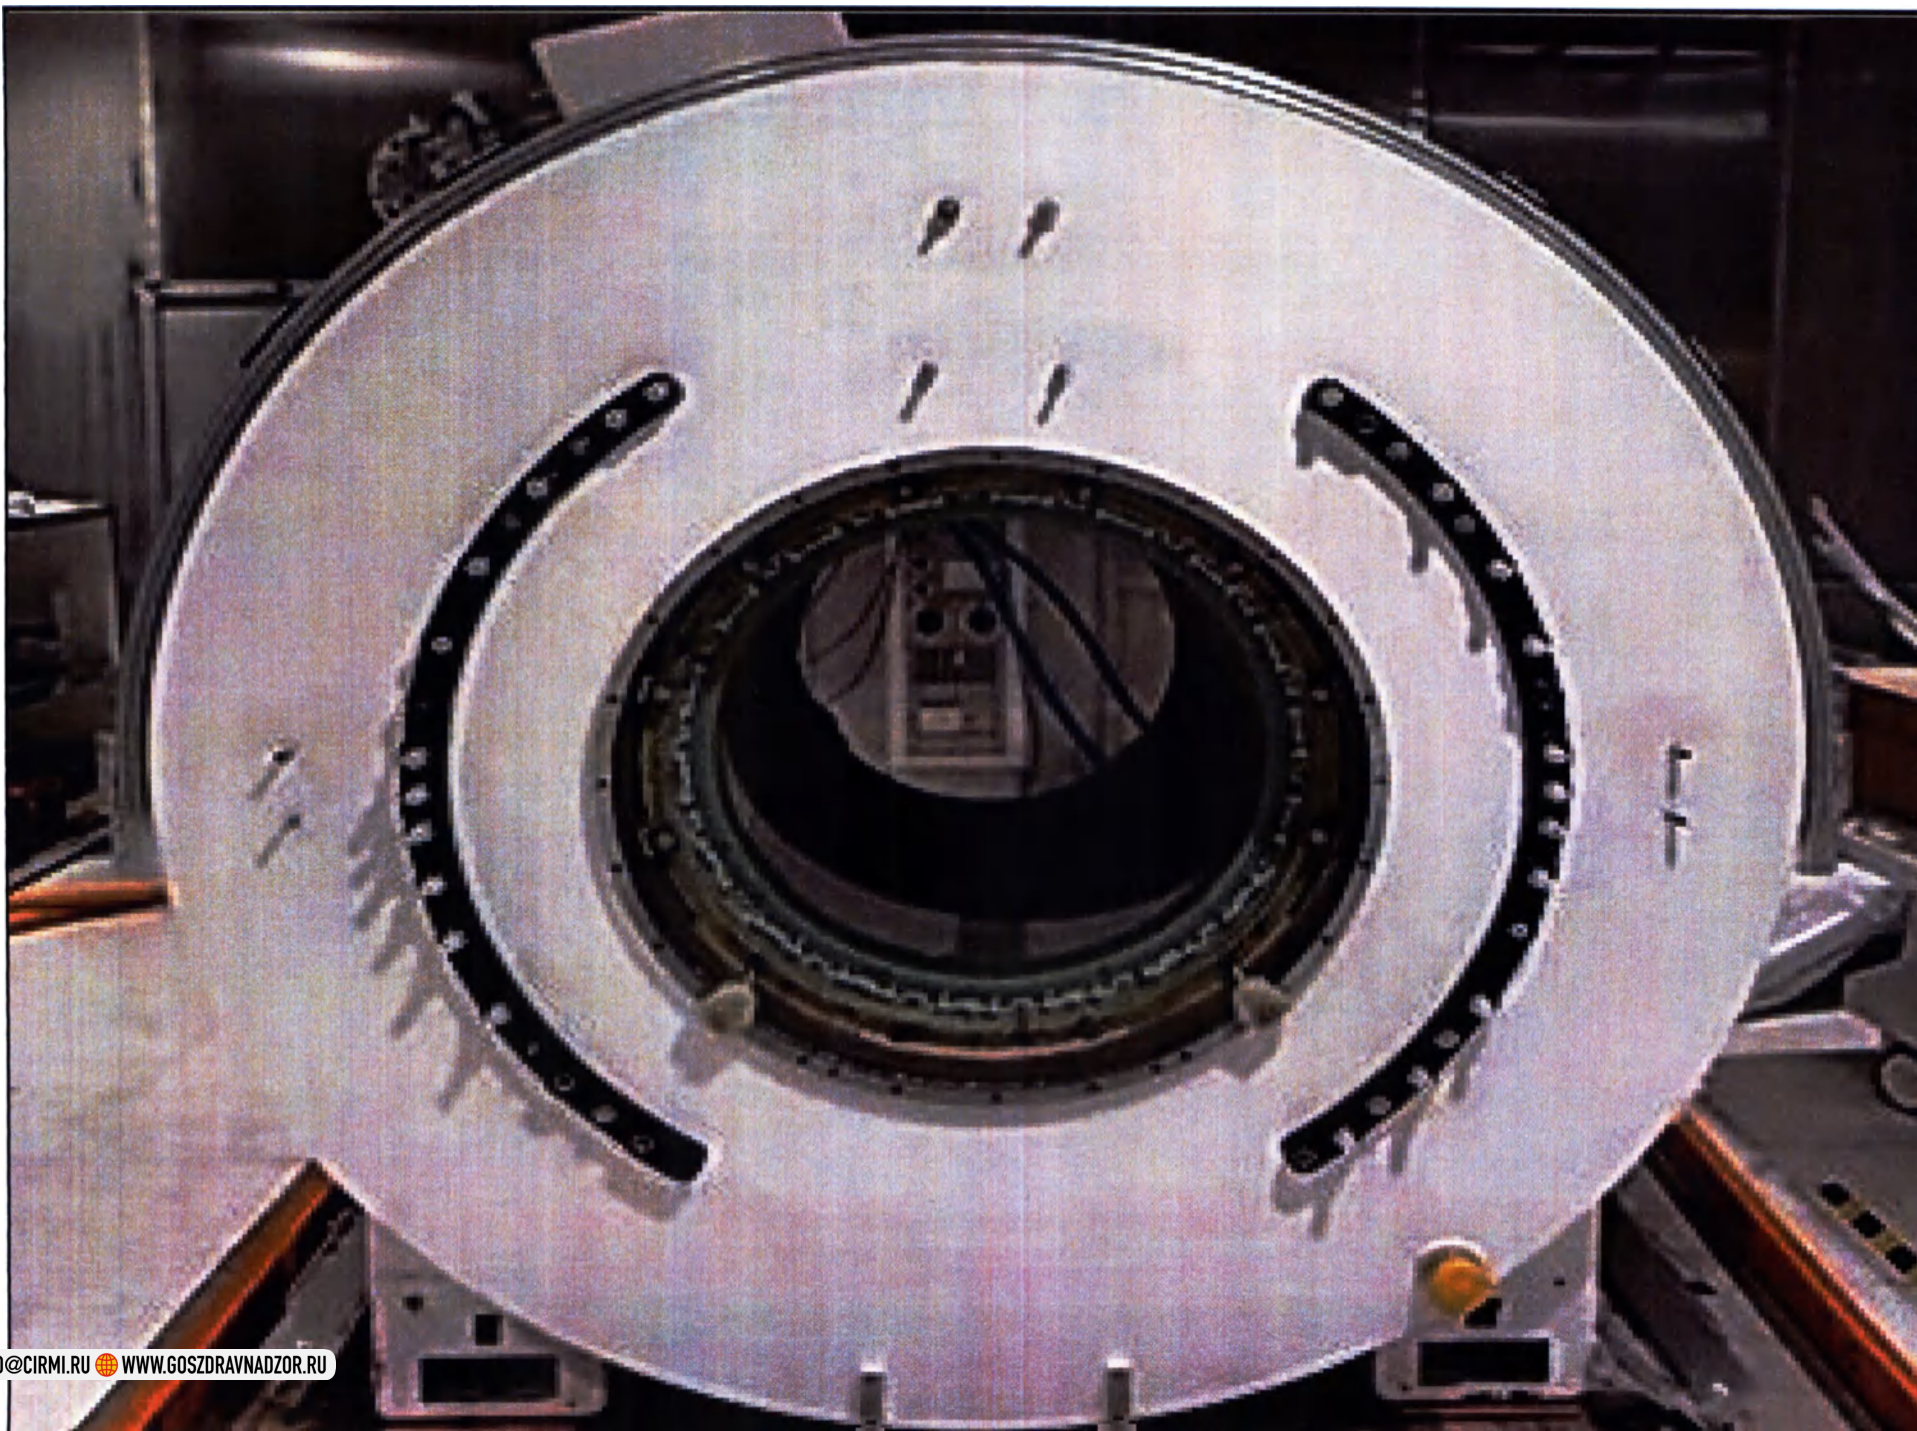


2. Градиентная катушка.

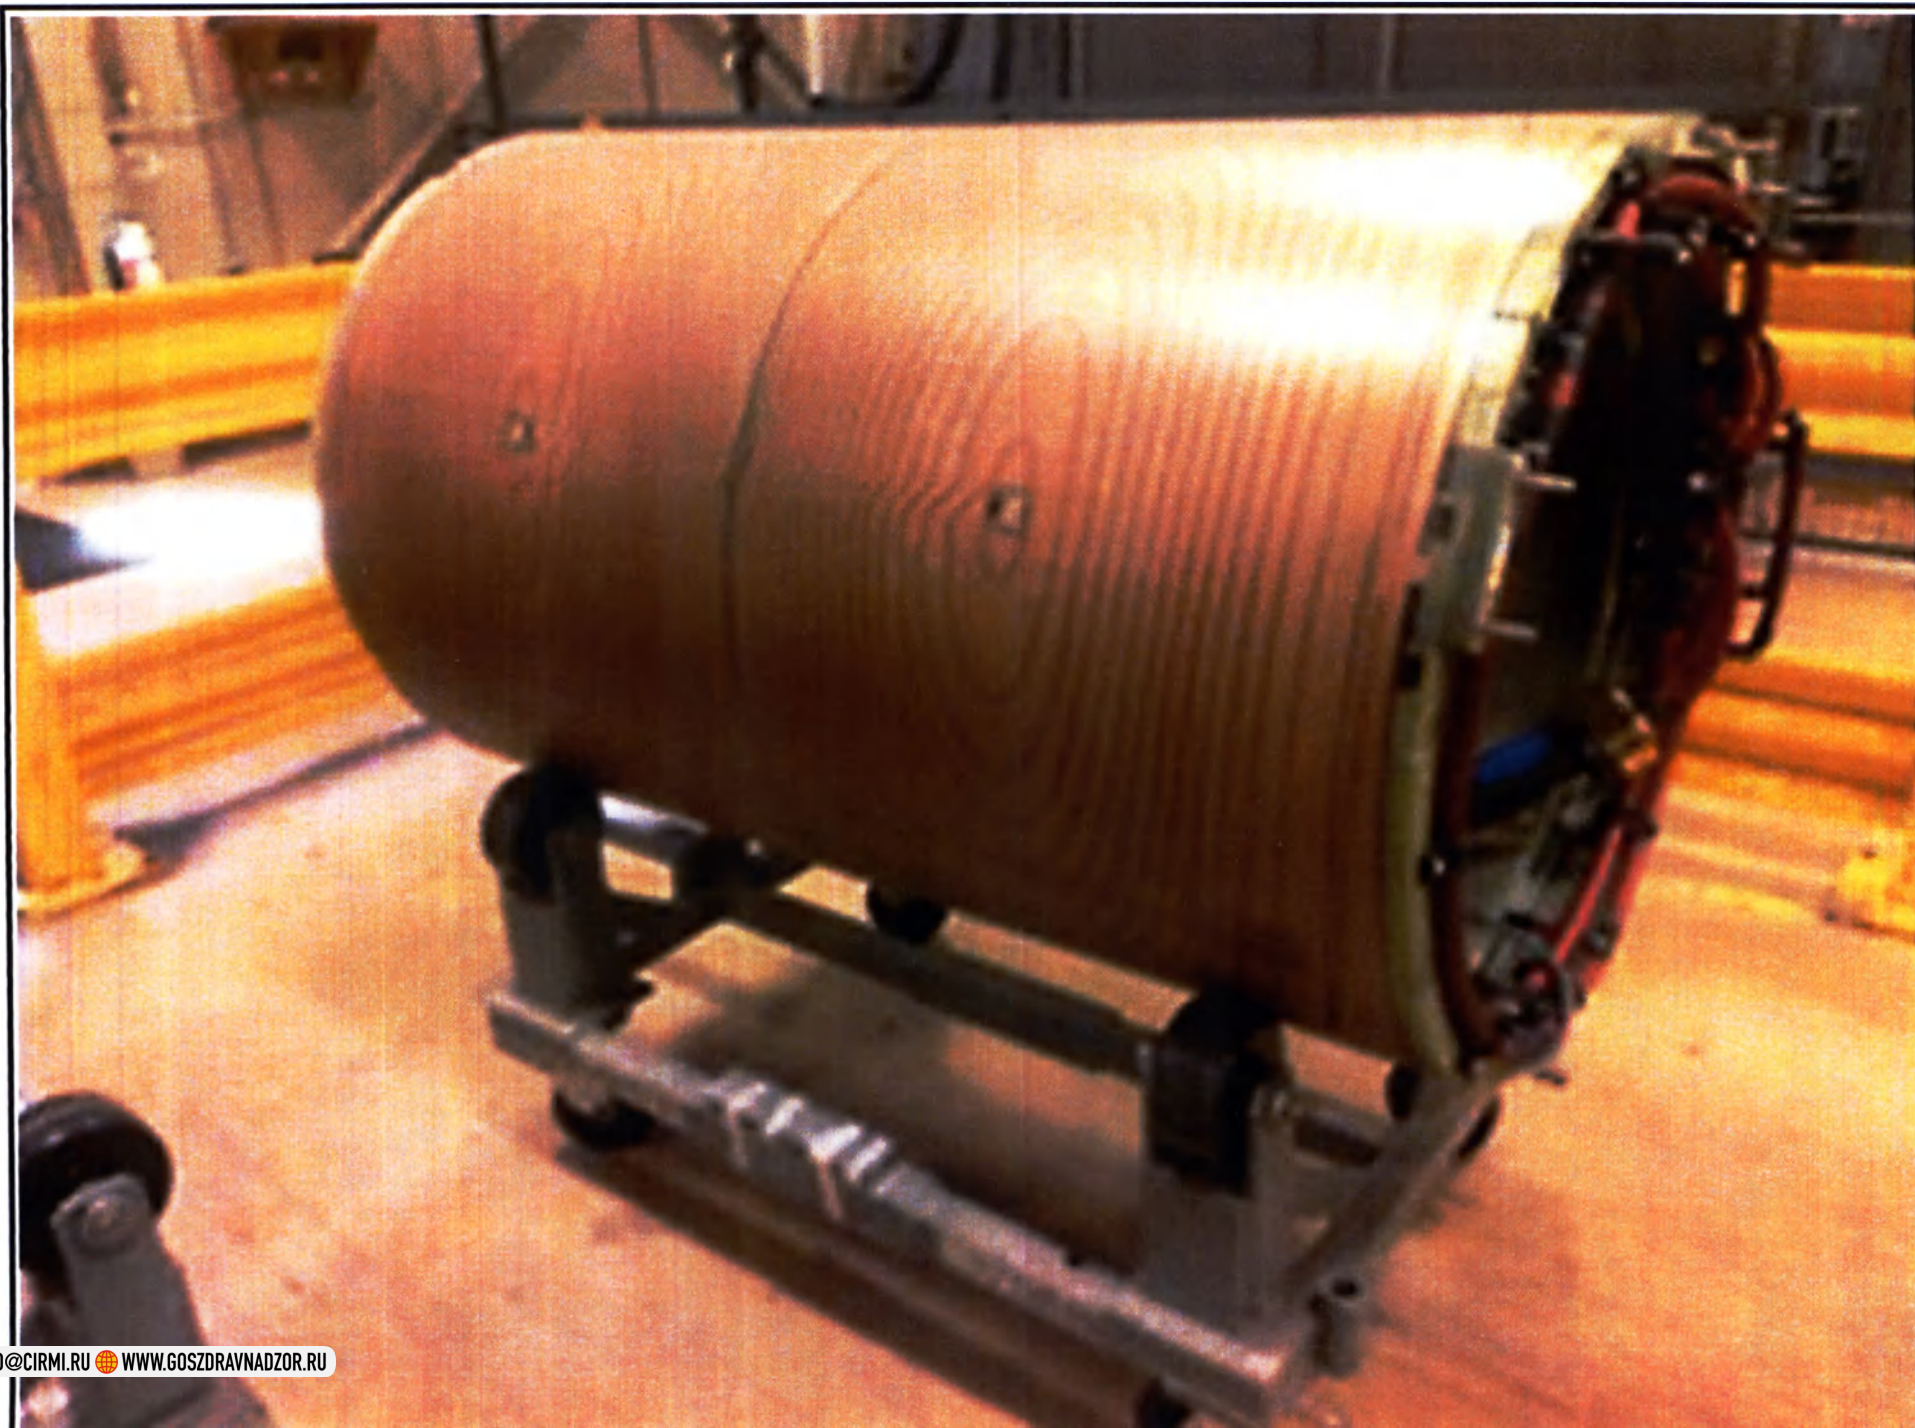


3. Пульт оператора (не более 5 шт.).




3. Пульт оператора (не более 5 шт.).

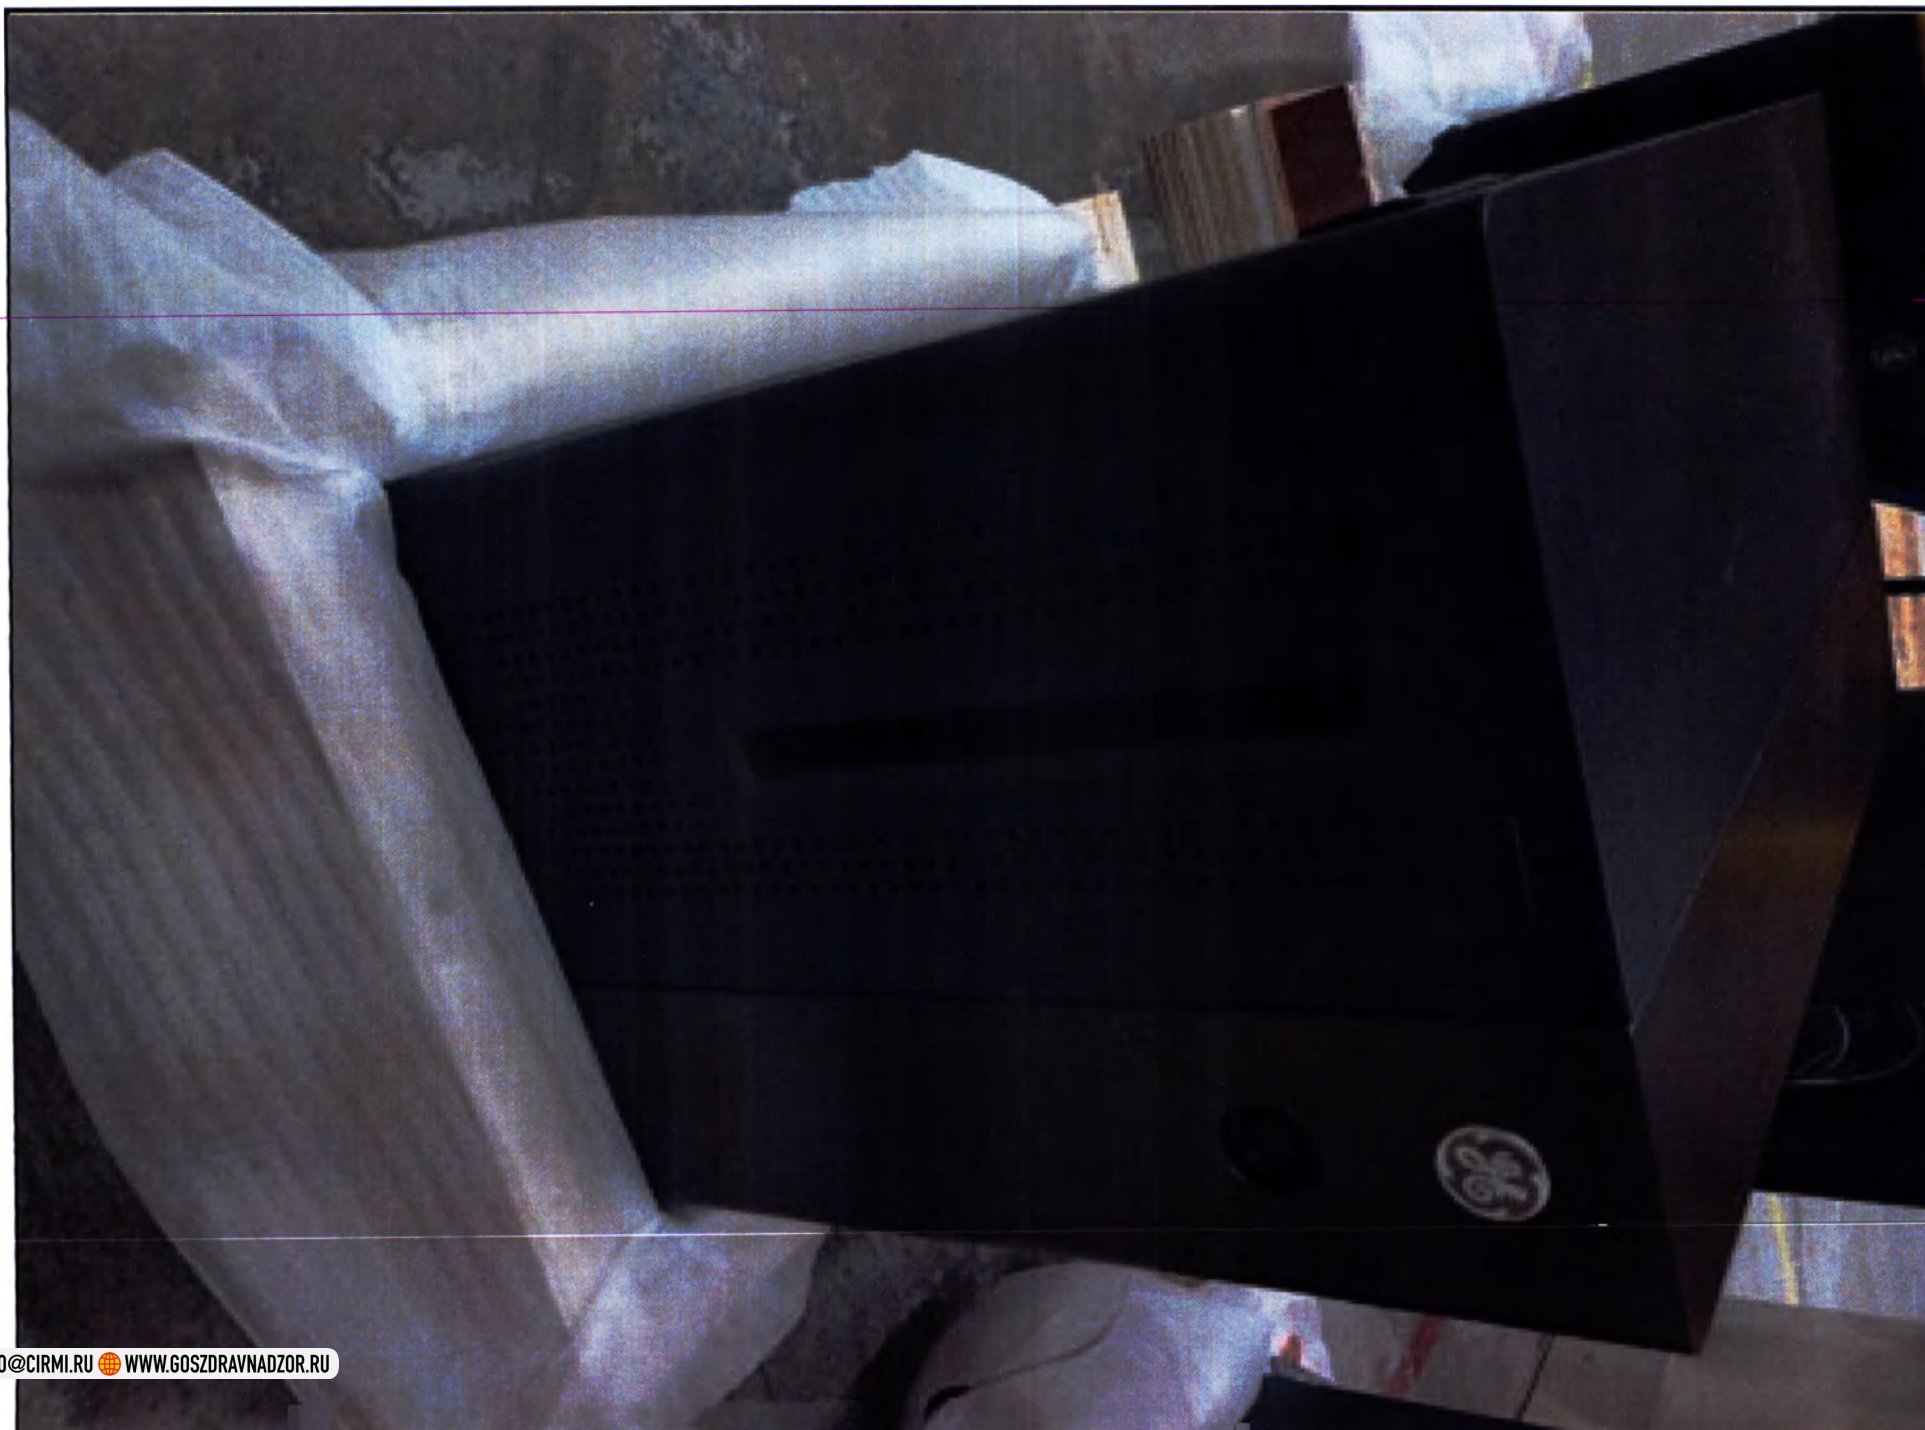


4. Шкафы управления системой (не более 10 шт.).

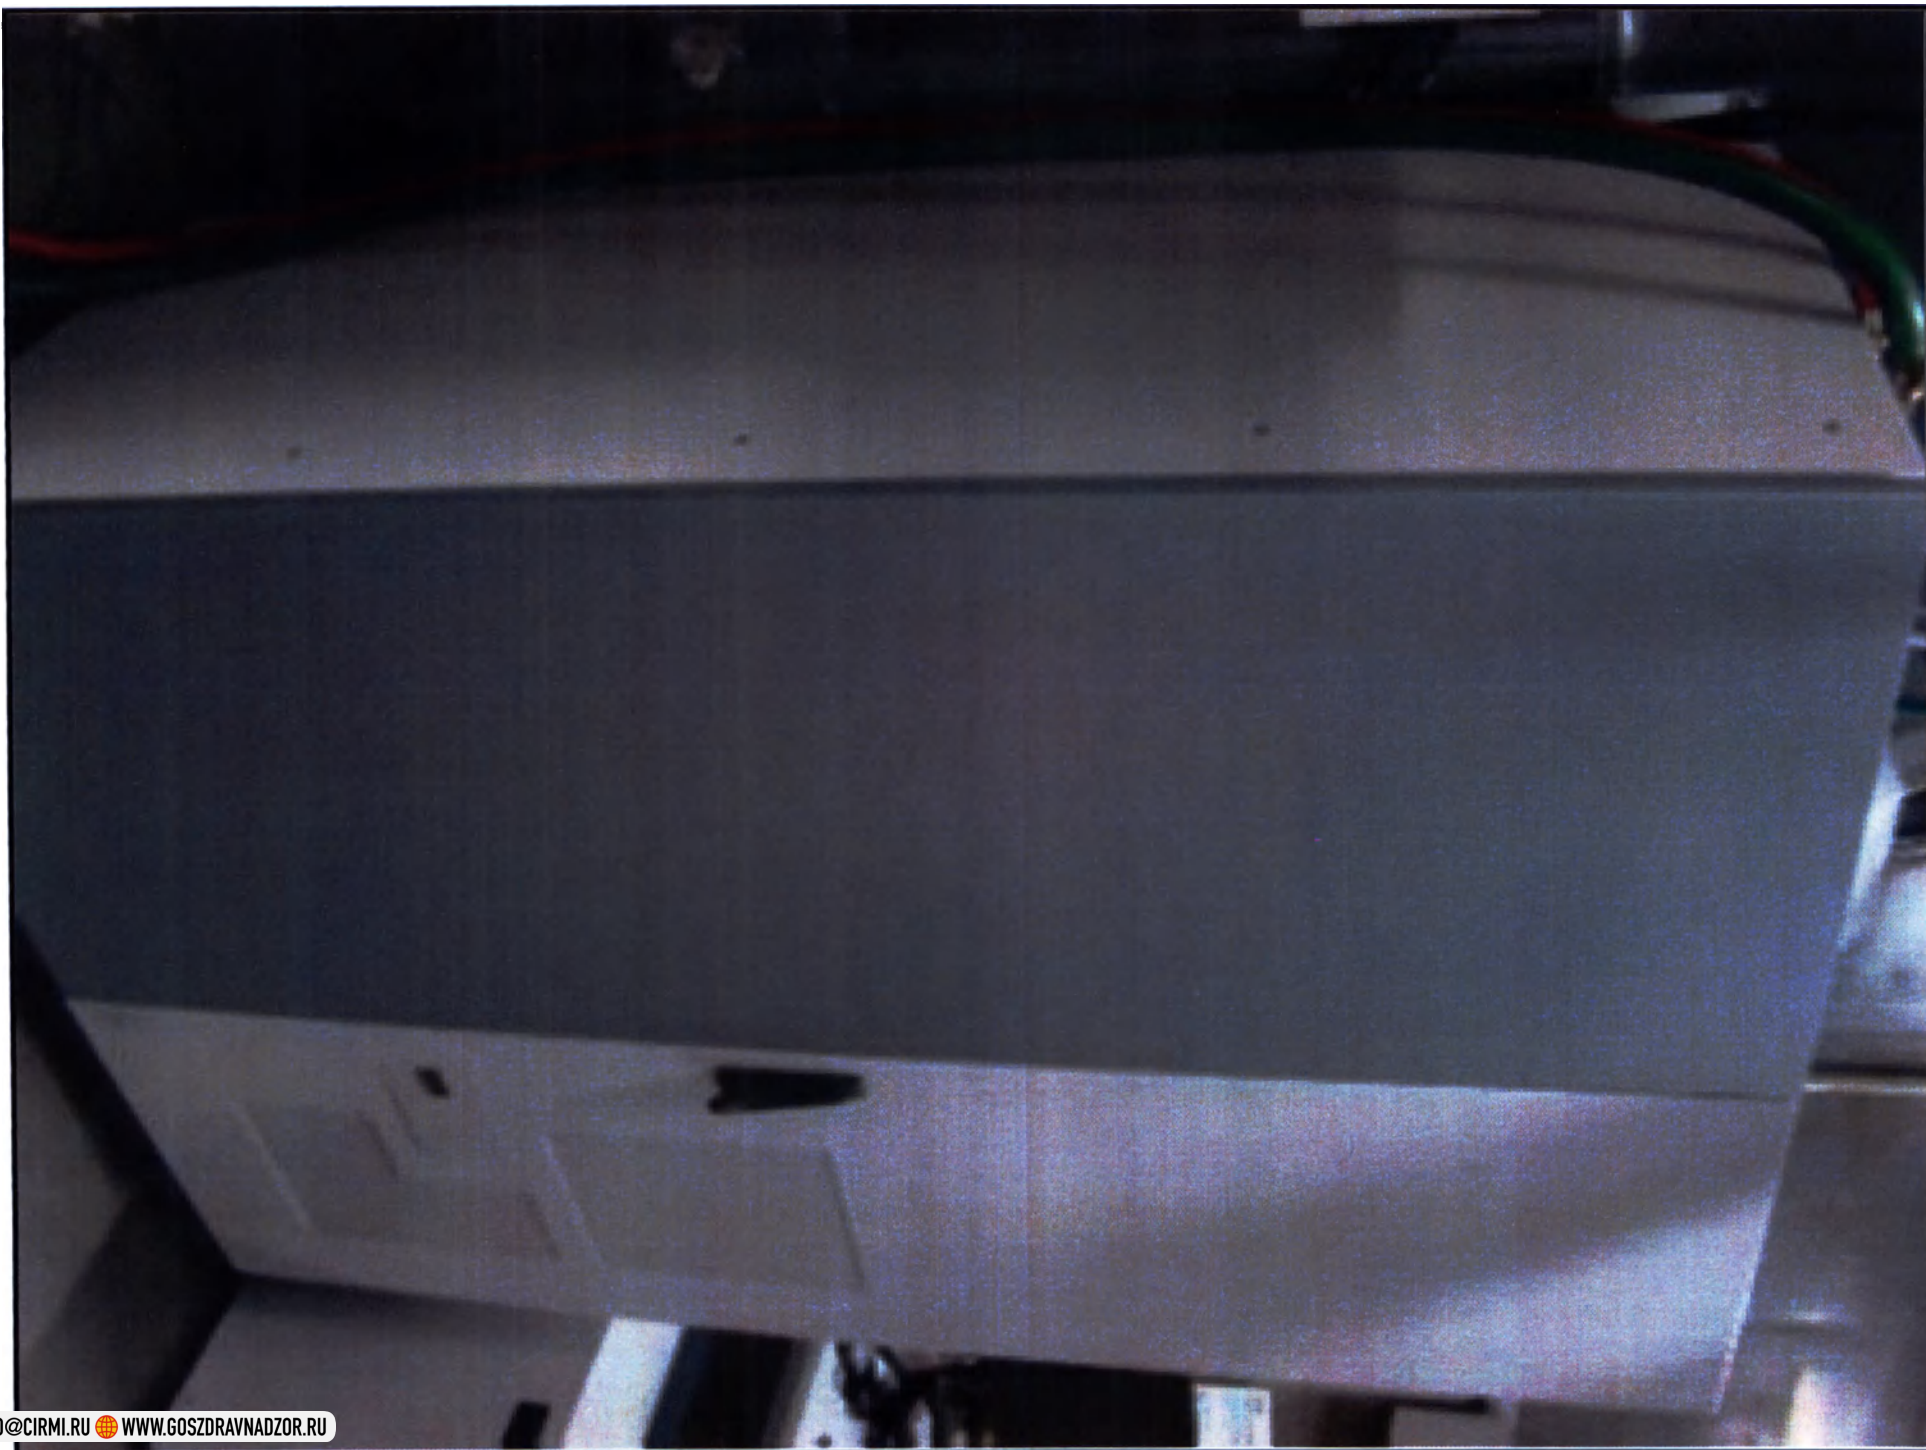

4. Шкафы управления системой (не более 10 шт.).

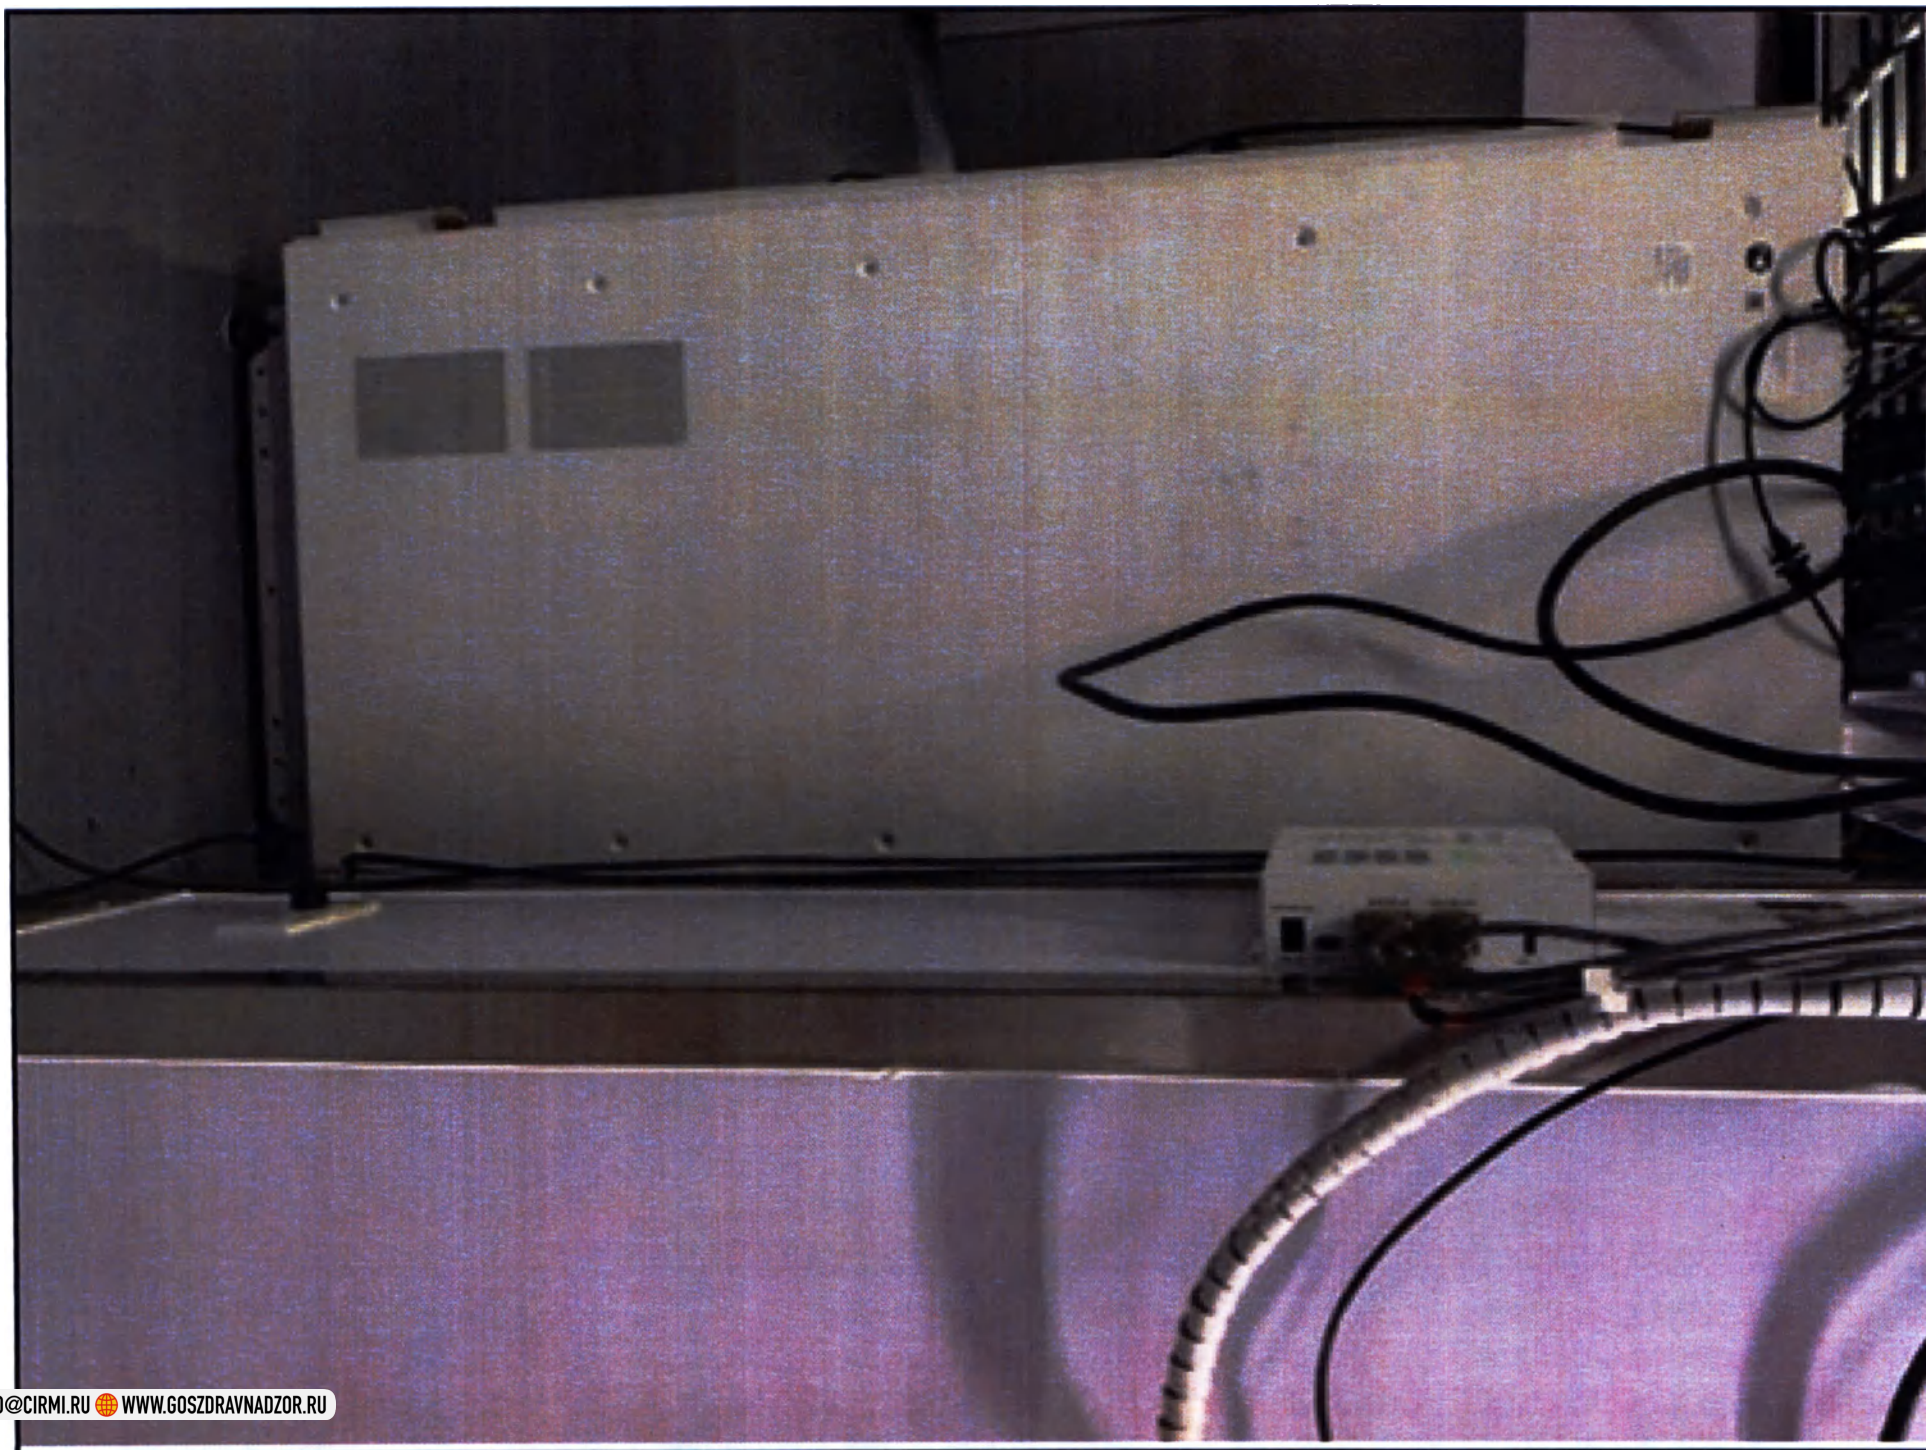

4. Шкафы управления системой (не более 10 шт.).

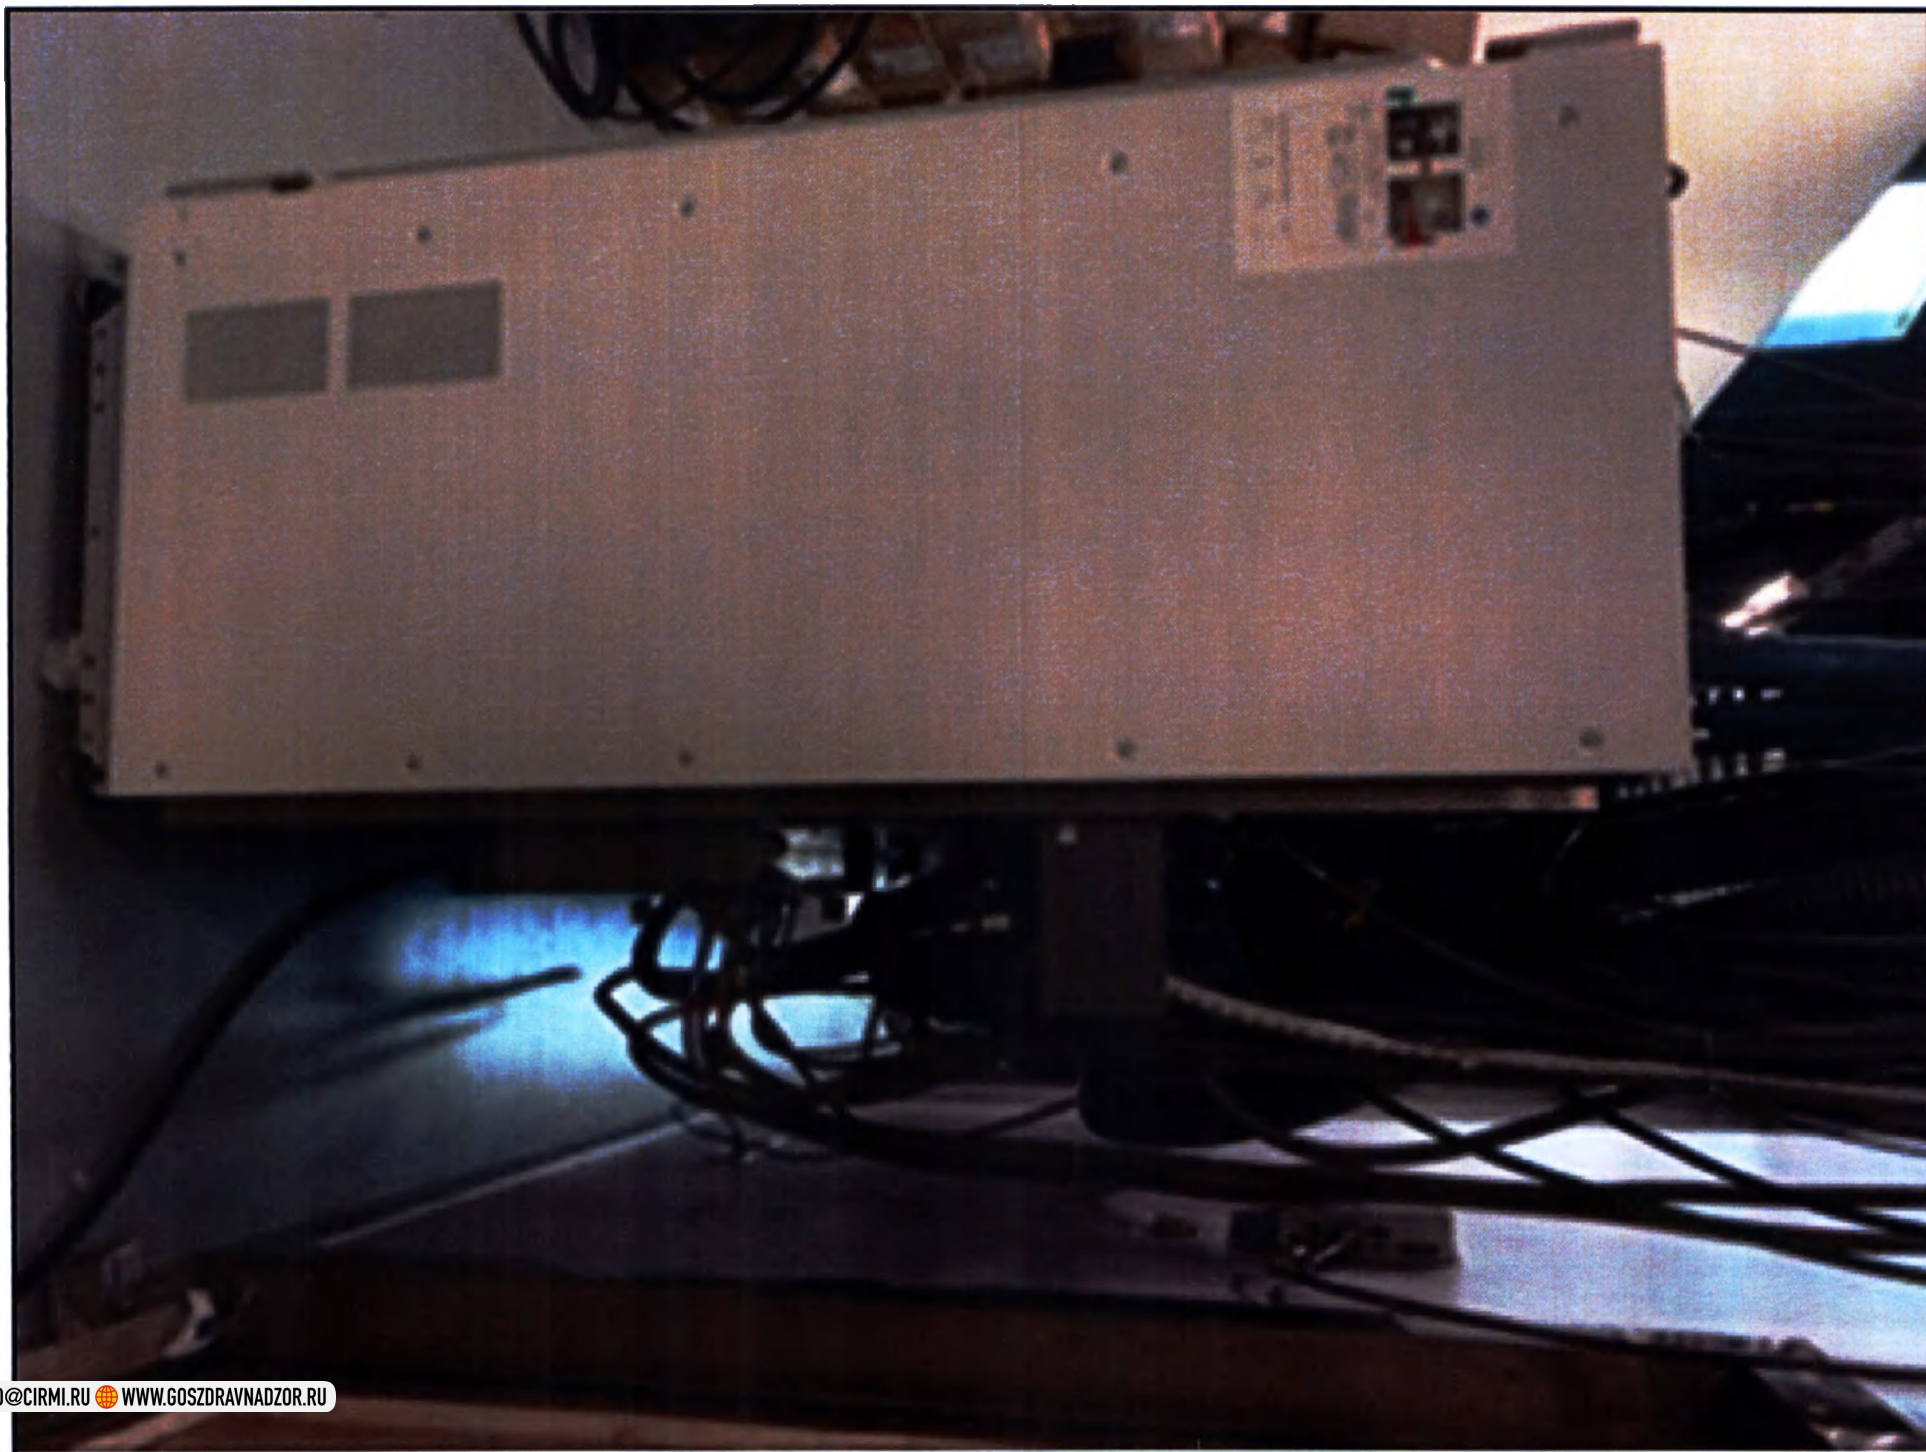



5. Стол пациента, варианты исполнения: стационарный, отсоединяемый (не более 2 шт.).



5. Стол пациента, варианты исполнения: стационарный, отсоединяемый (не более 2 шт.).



SIGNA Voyager

Руководство оператора



SIGNA Voyager

Руководство пользователя, русский язык

5871613-299 на русском (2021-06) ред. 3

© 2021 General Electric Company

Все права защищены.


Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager

Руководство оператора



Томограф магнитно-резонансный SIGNA Voyager
Руководство пользователя, русский язык
5880711-299 на русском (2021-10) ред. 1
© 2021 General Electric Company
Все права защищены.

7. Мониторы для пульта оператора (не более 5 шт.).

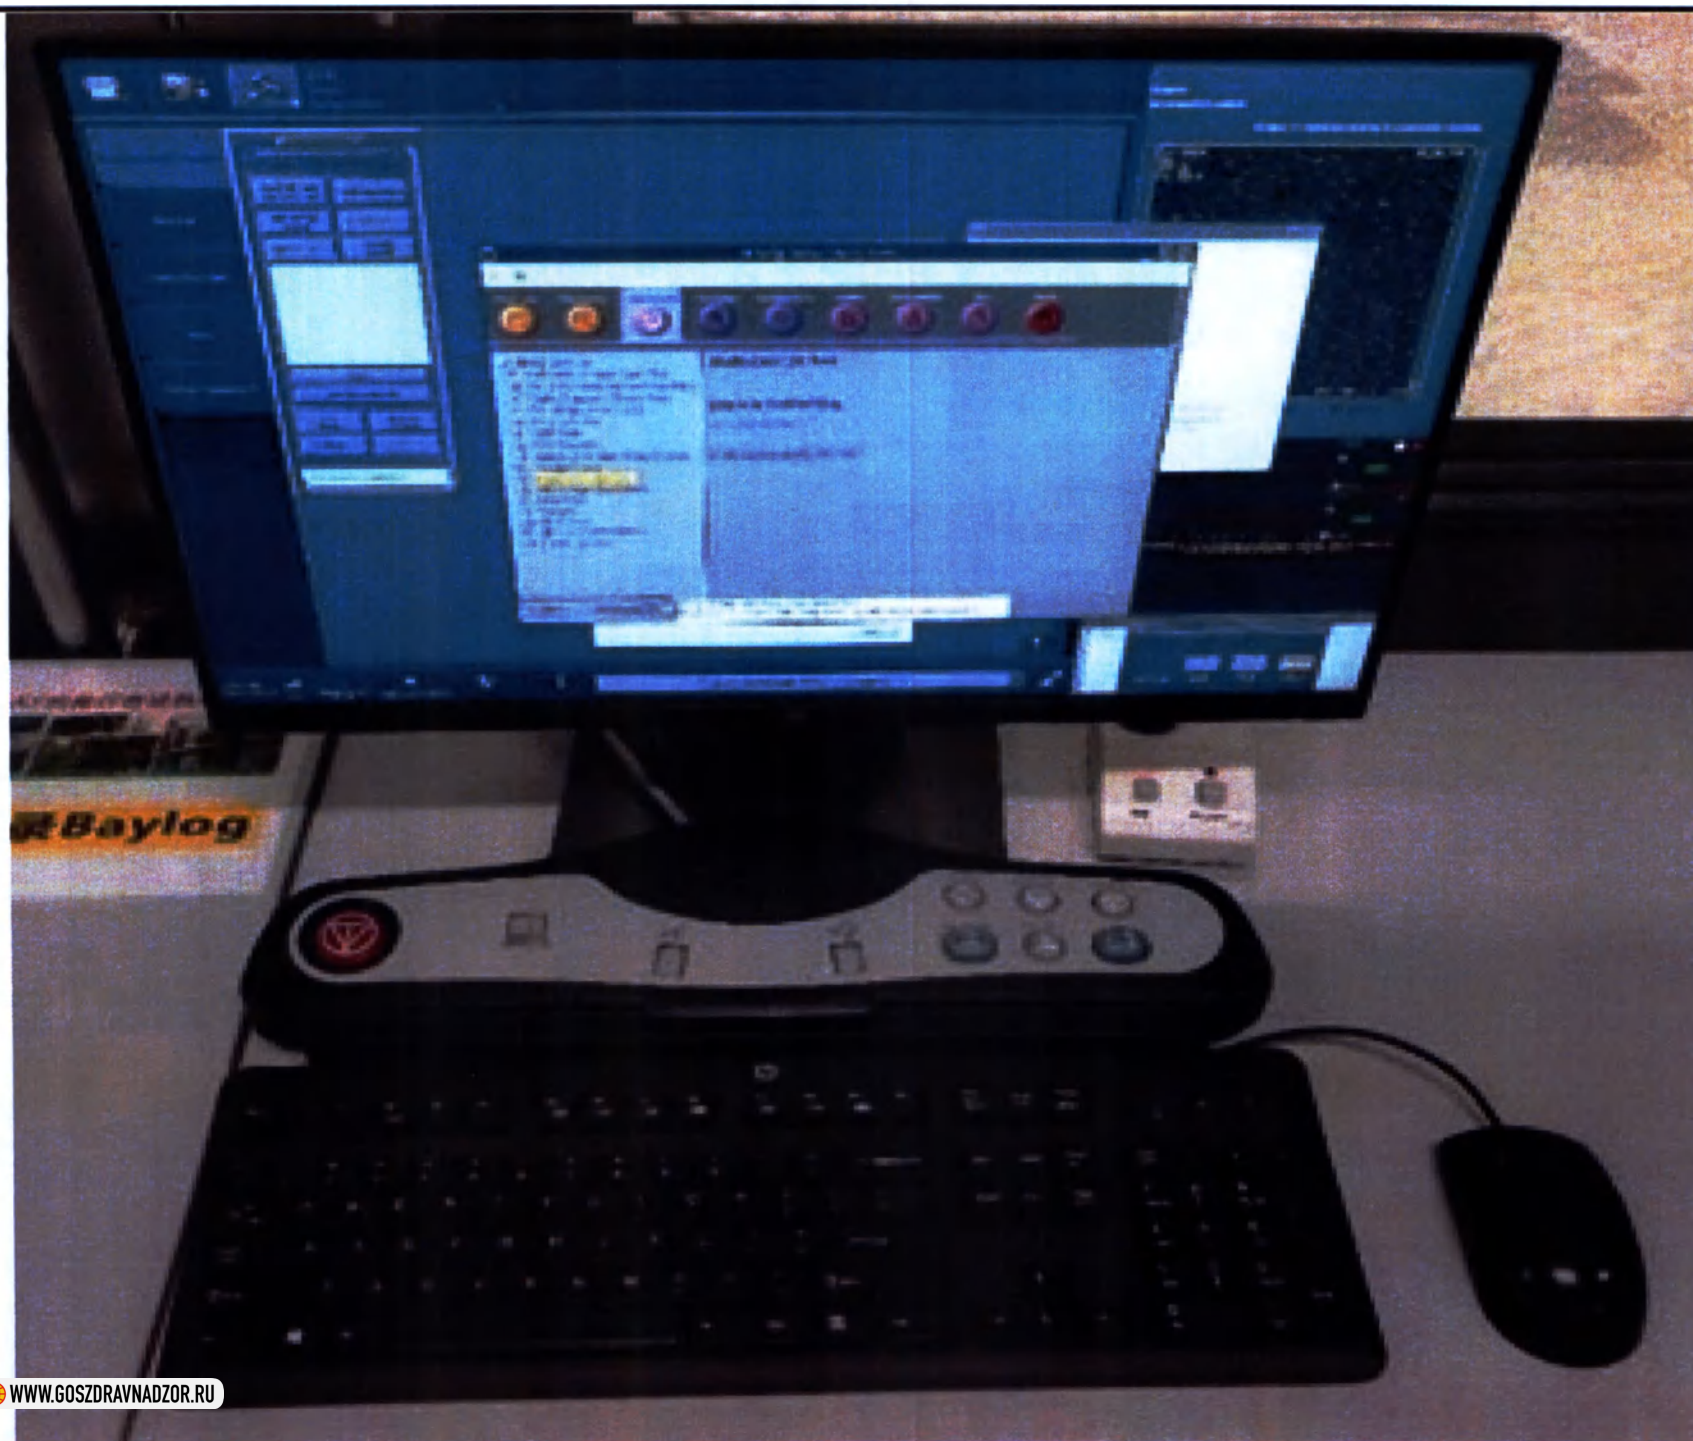

7. Мониторы для пульты оператора (не более 5 шт.).



7. Мониторы для пульта оператора (не более 5 шт.).




7. Мониторы для пульта оператора (не более 5 шт.).



7. Мониторы для пульта оператора (не более 5 шт.).




II. Принадлежности: 1. Устройство отключения магнита.

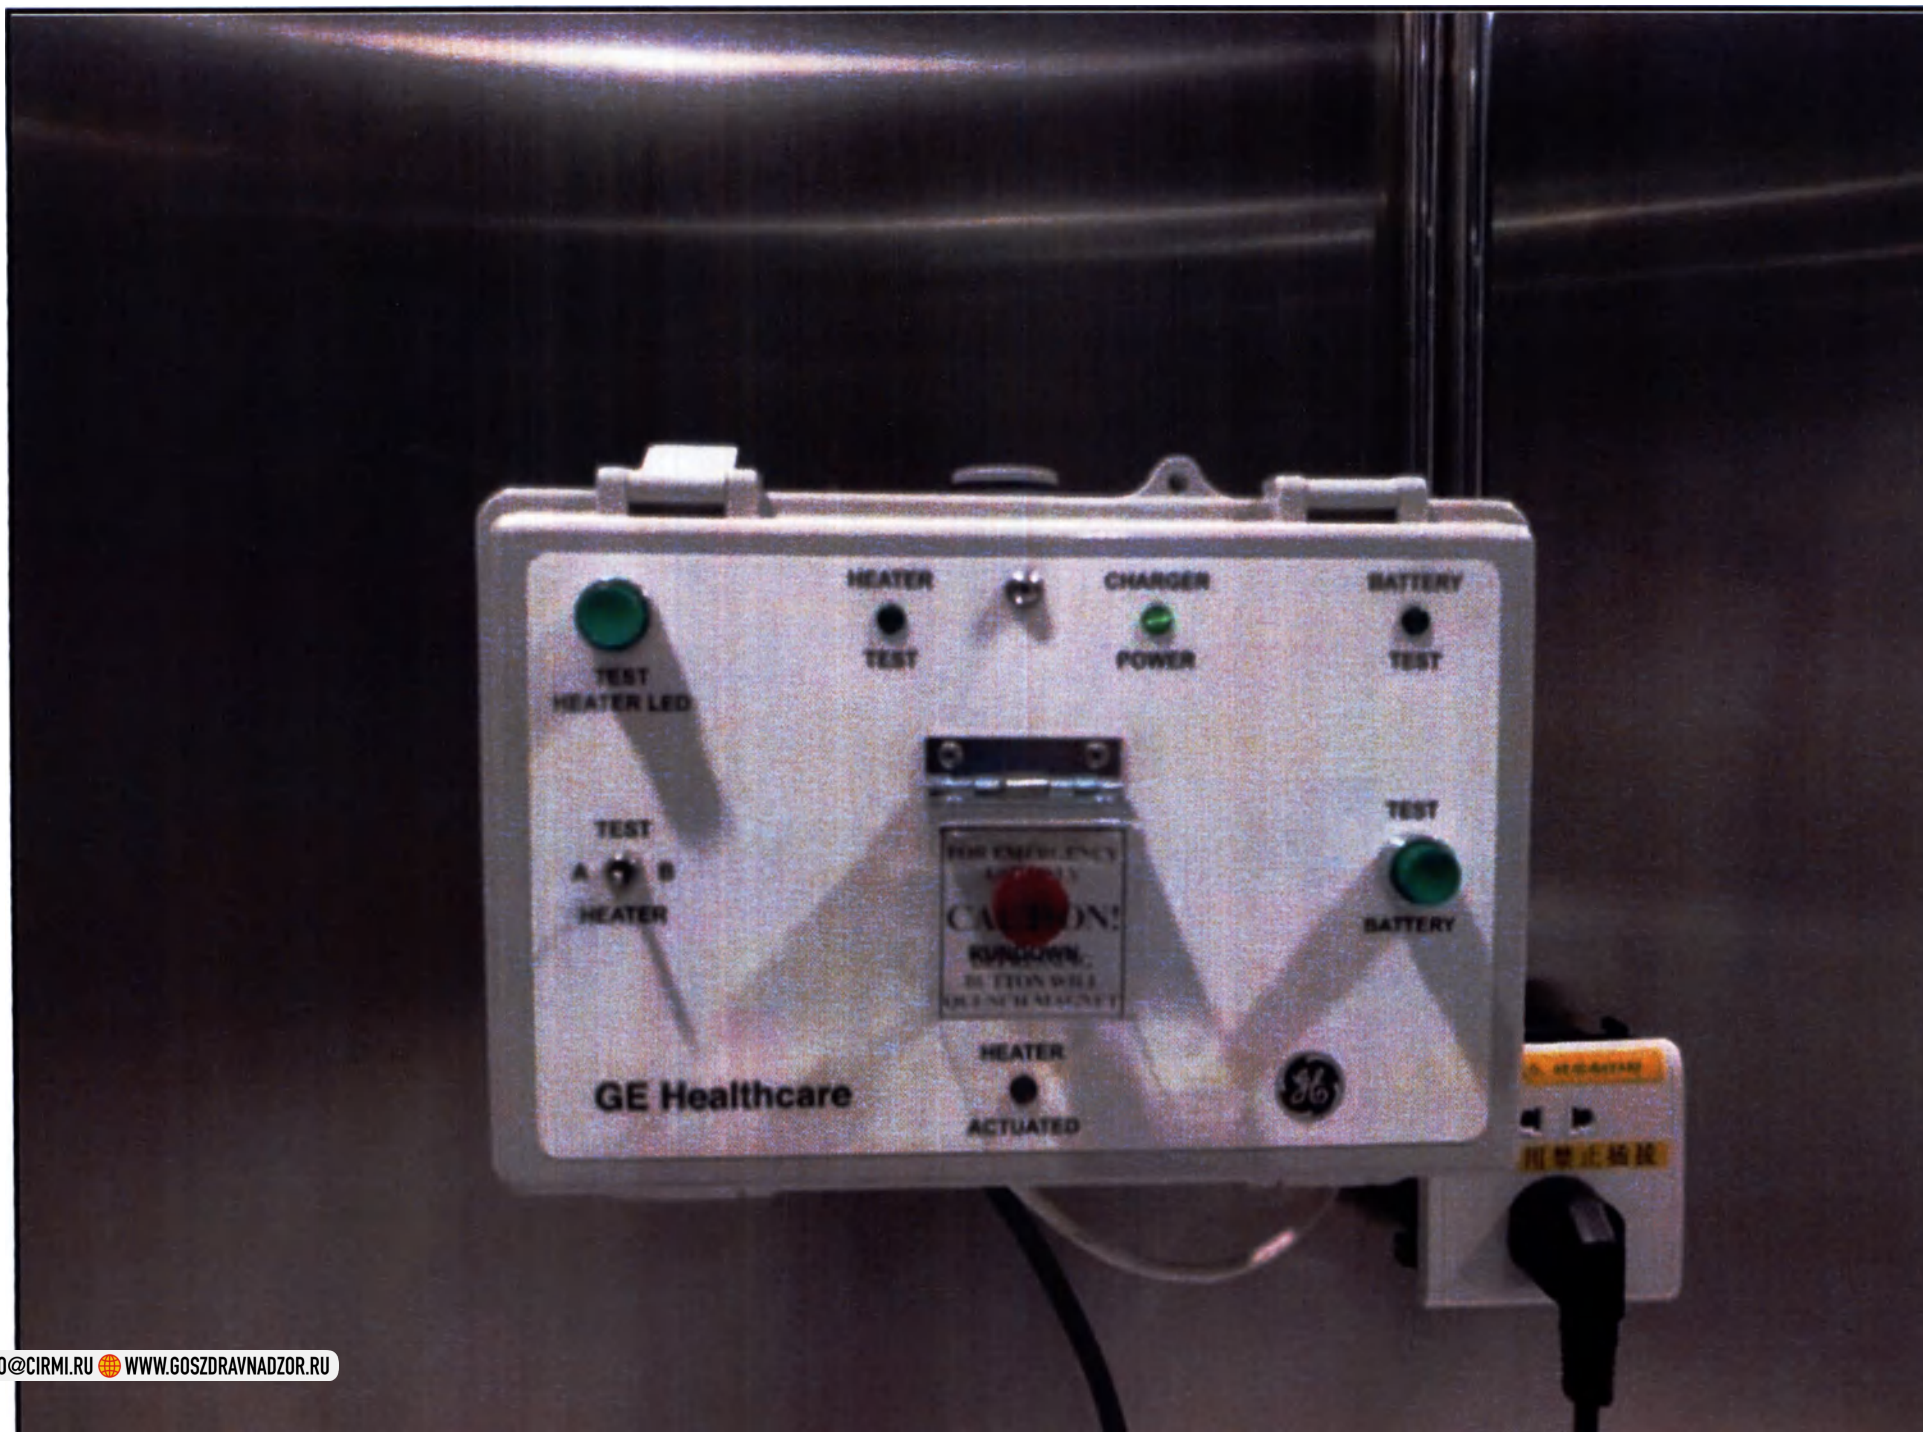


II. Принадлежности: 1. Устройство отключения магнита.



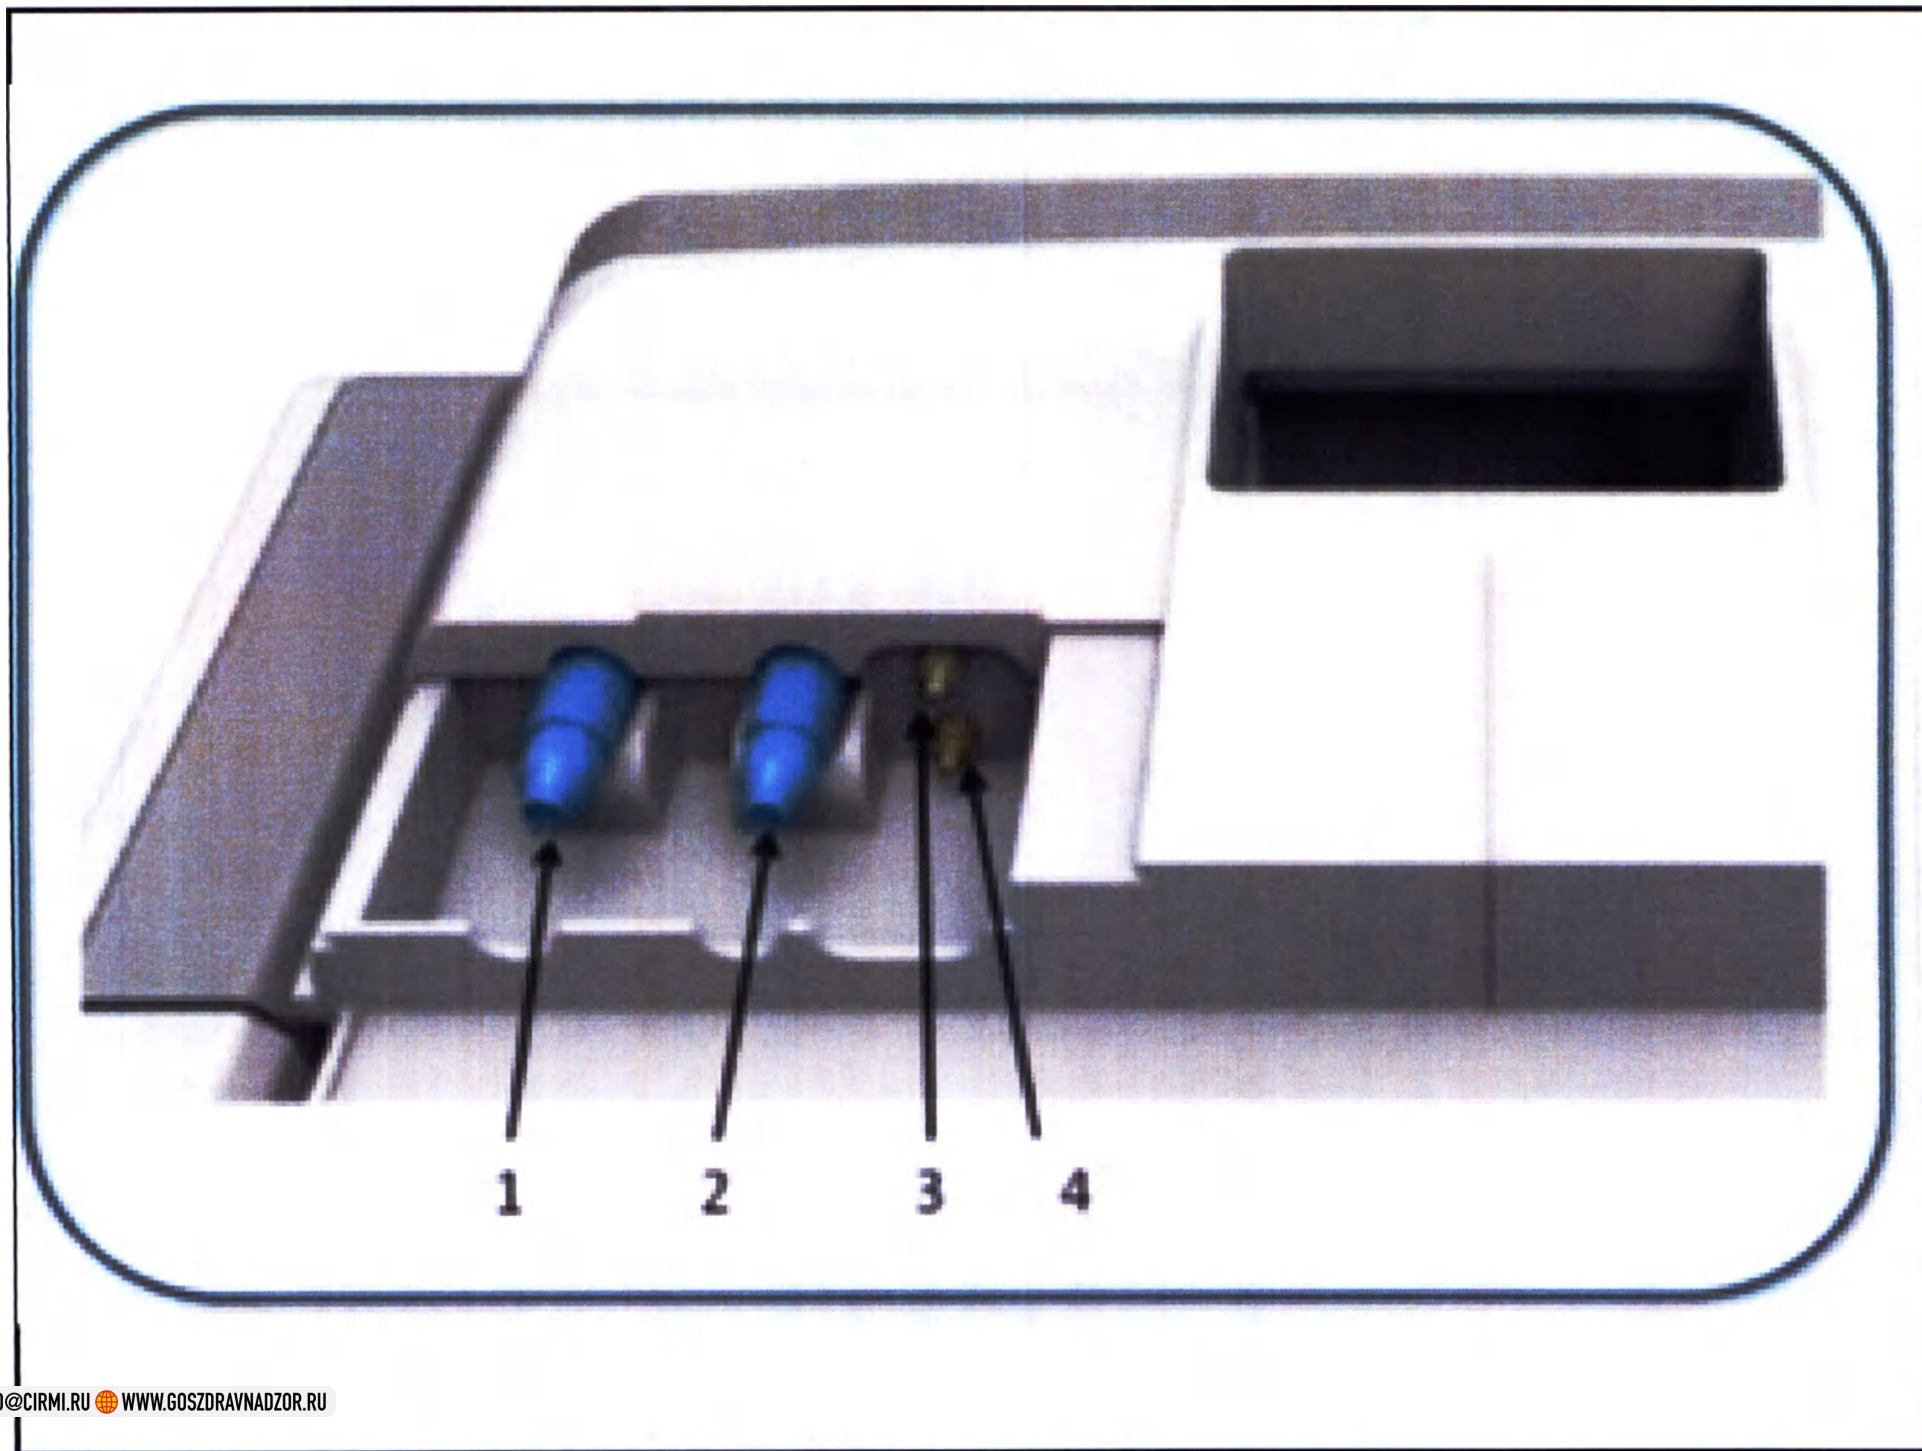


2. Устройство контроля физиологических данных РАС.

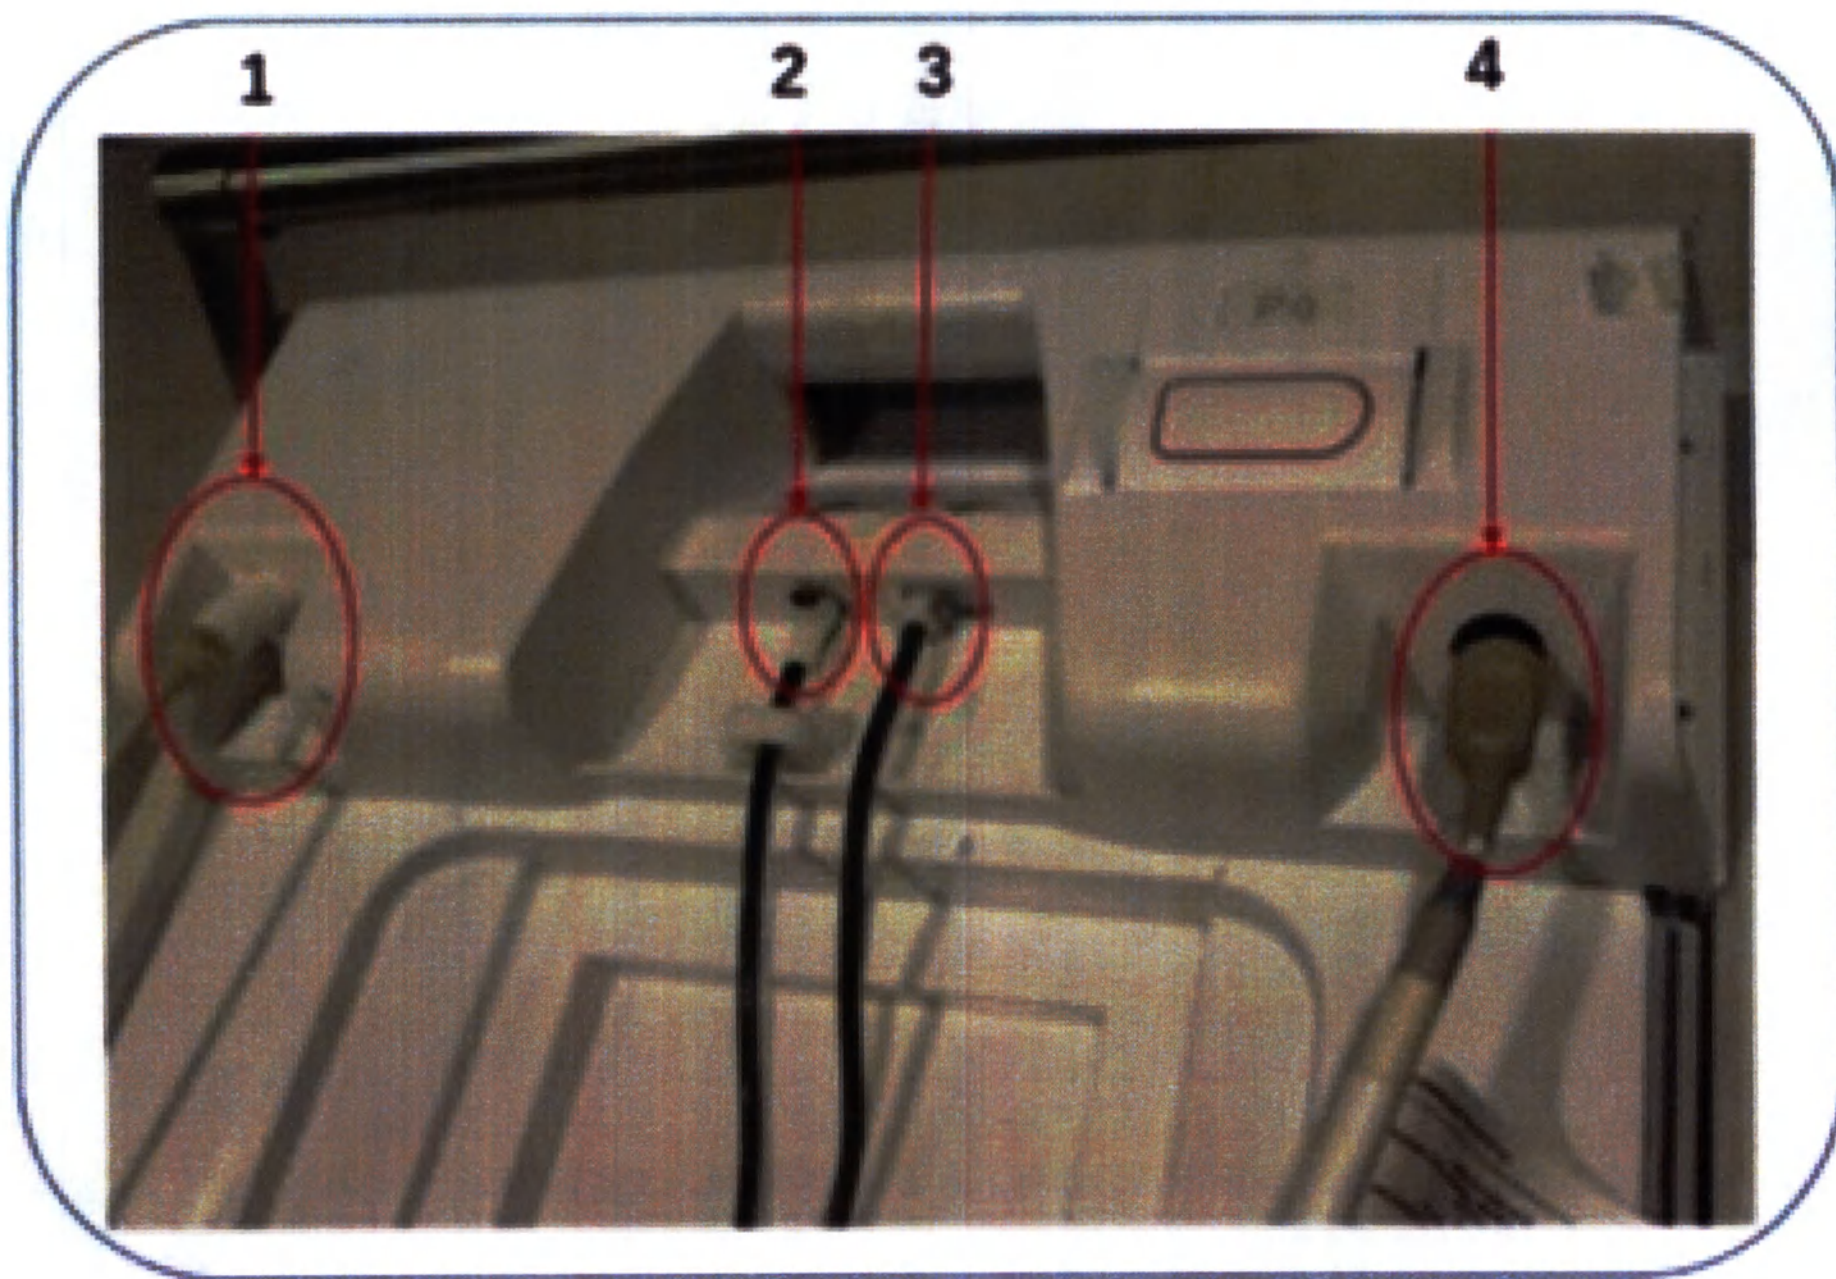

3. Стул оператора (не более 5 шт.).




4. Стол оператора (не более 5 шт.).

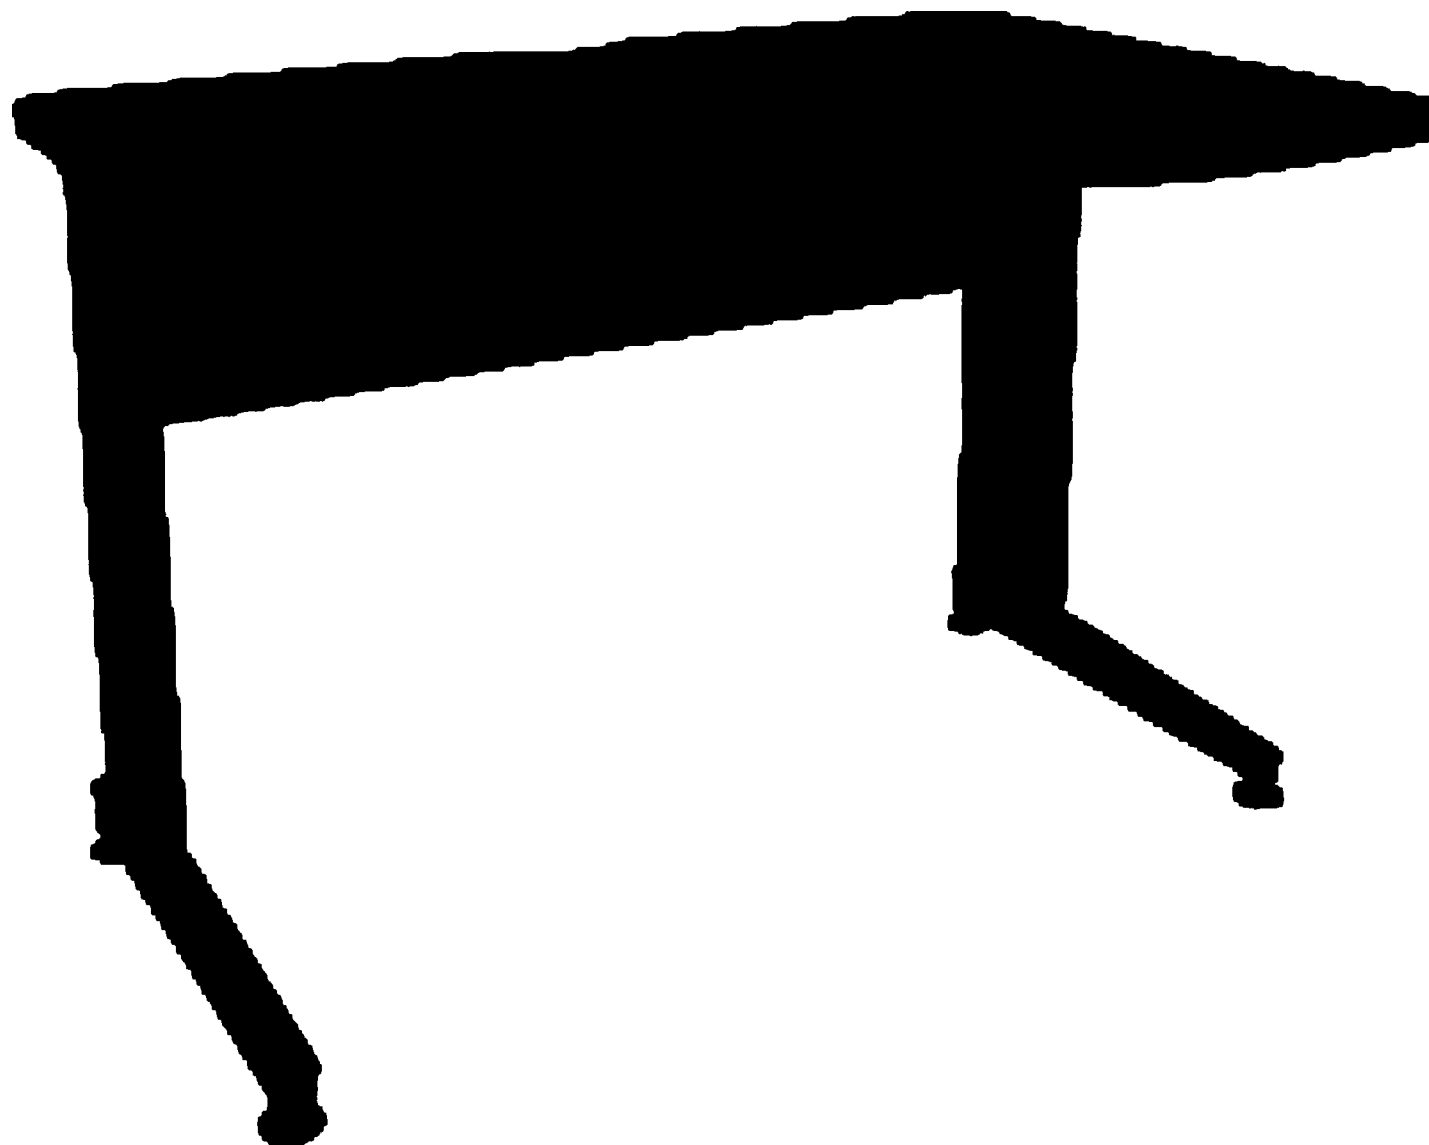

4. Стол оператора (не более 5 шт.).



5. Клавиатуры специальные (не более 5 шт.).

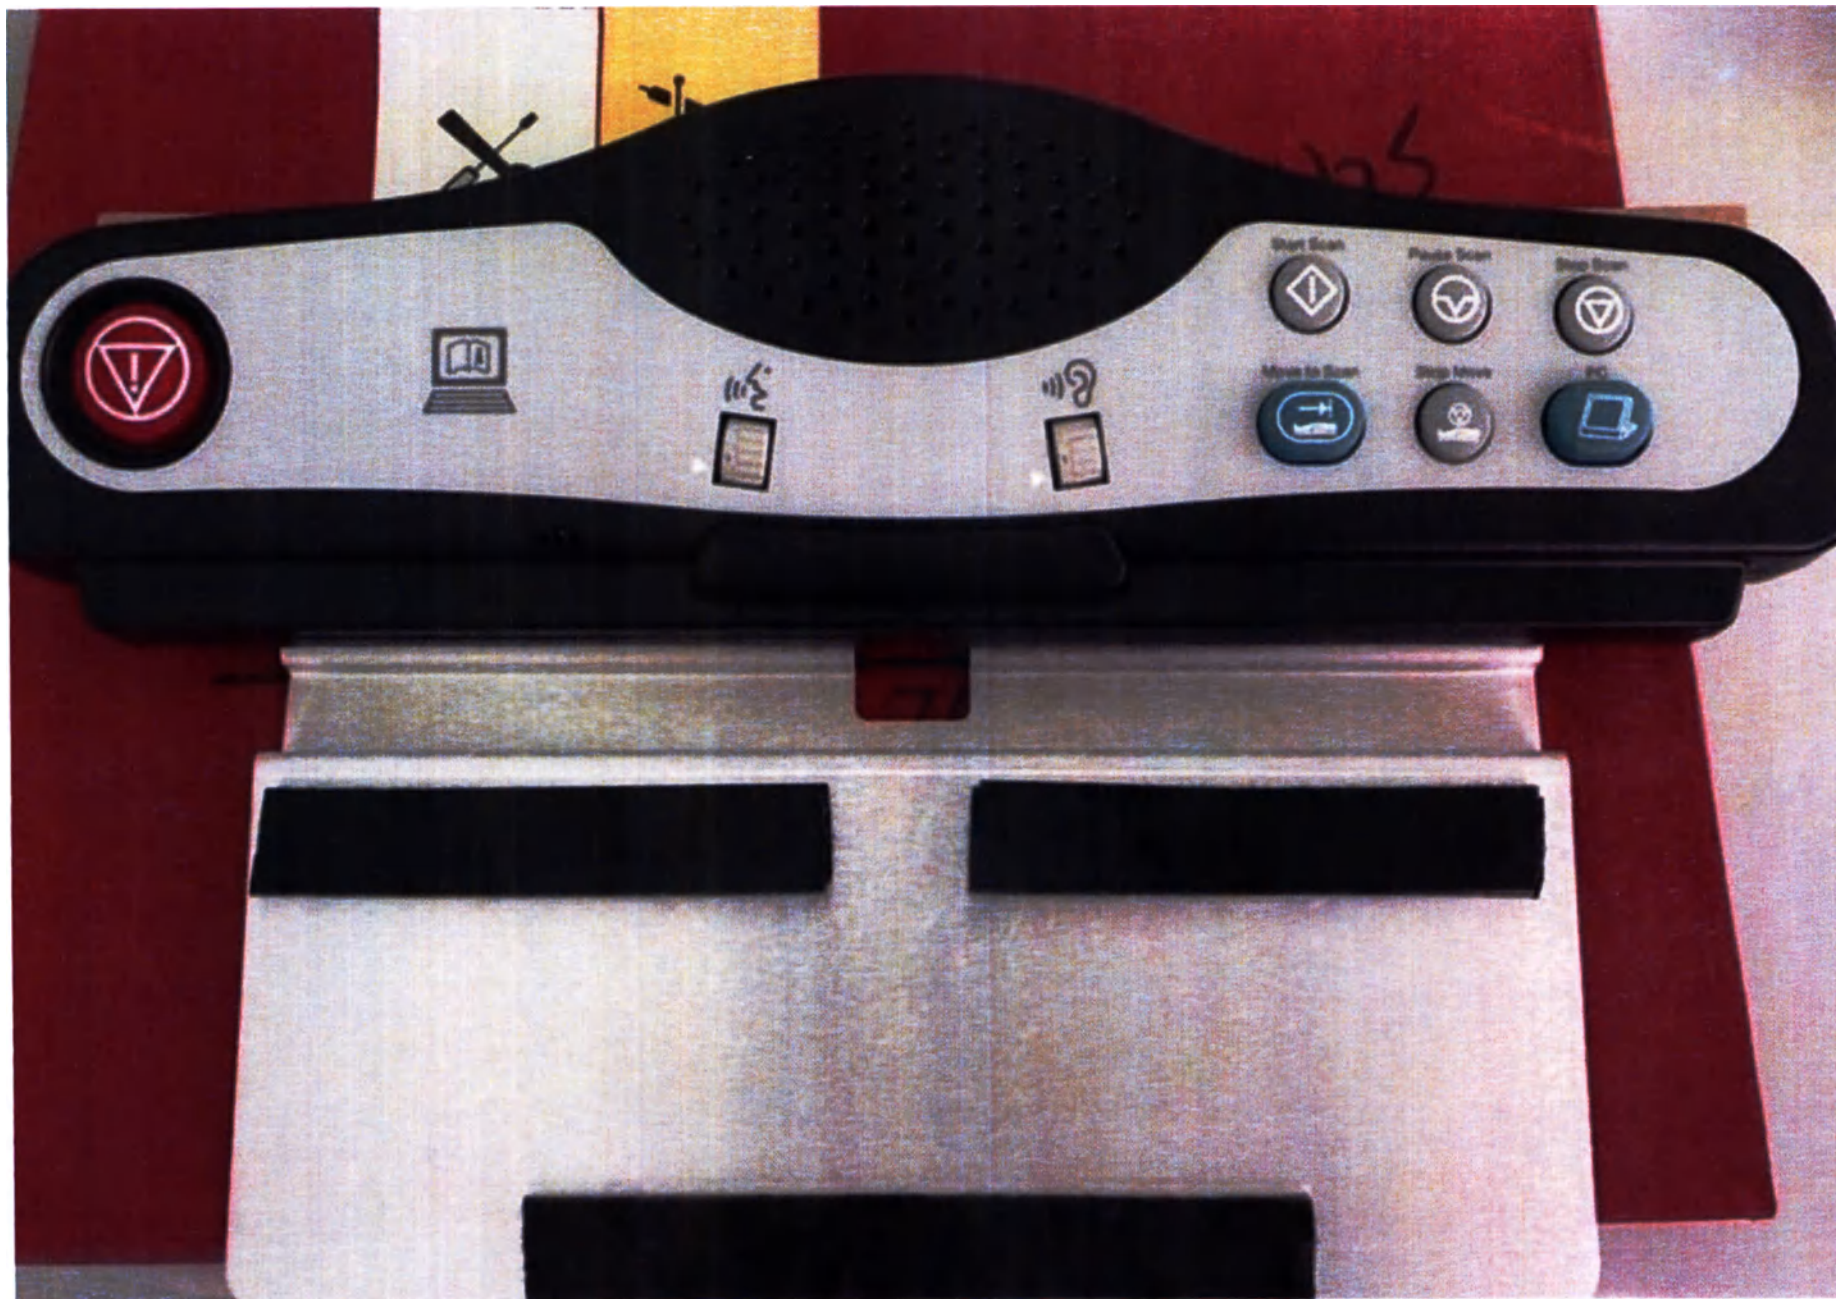


6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).




6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).



6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).

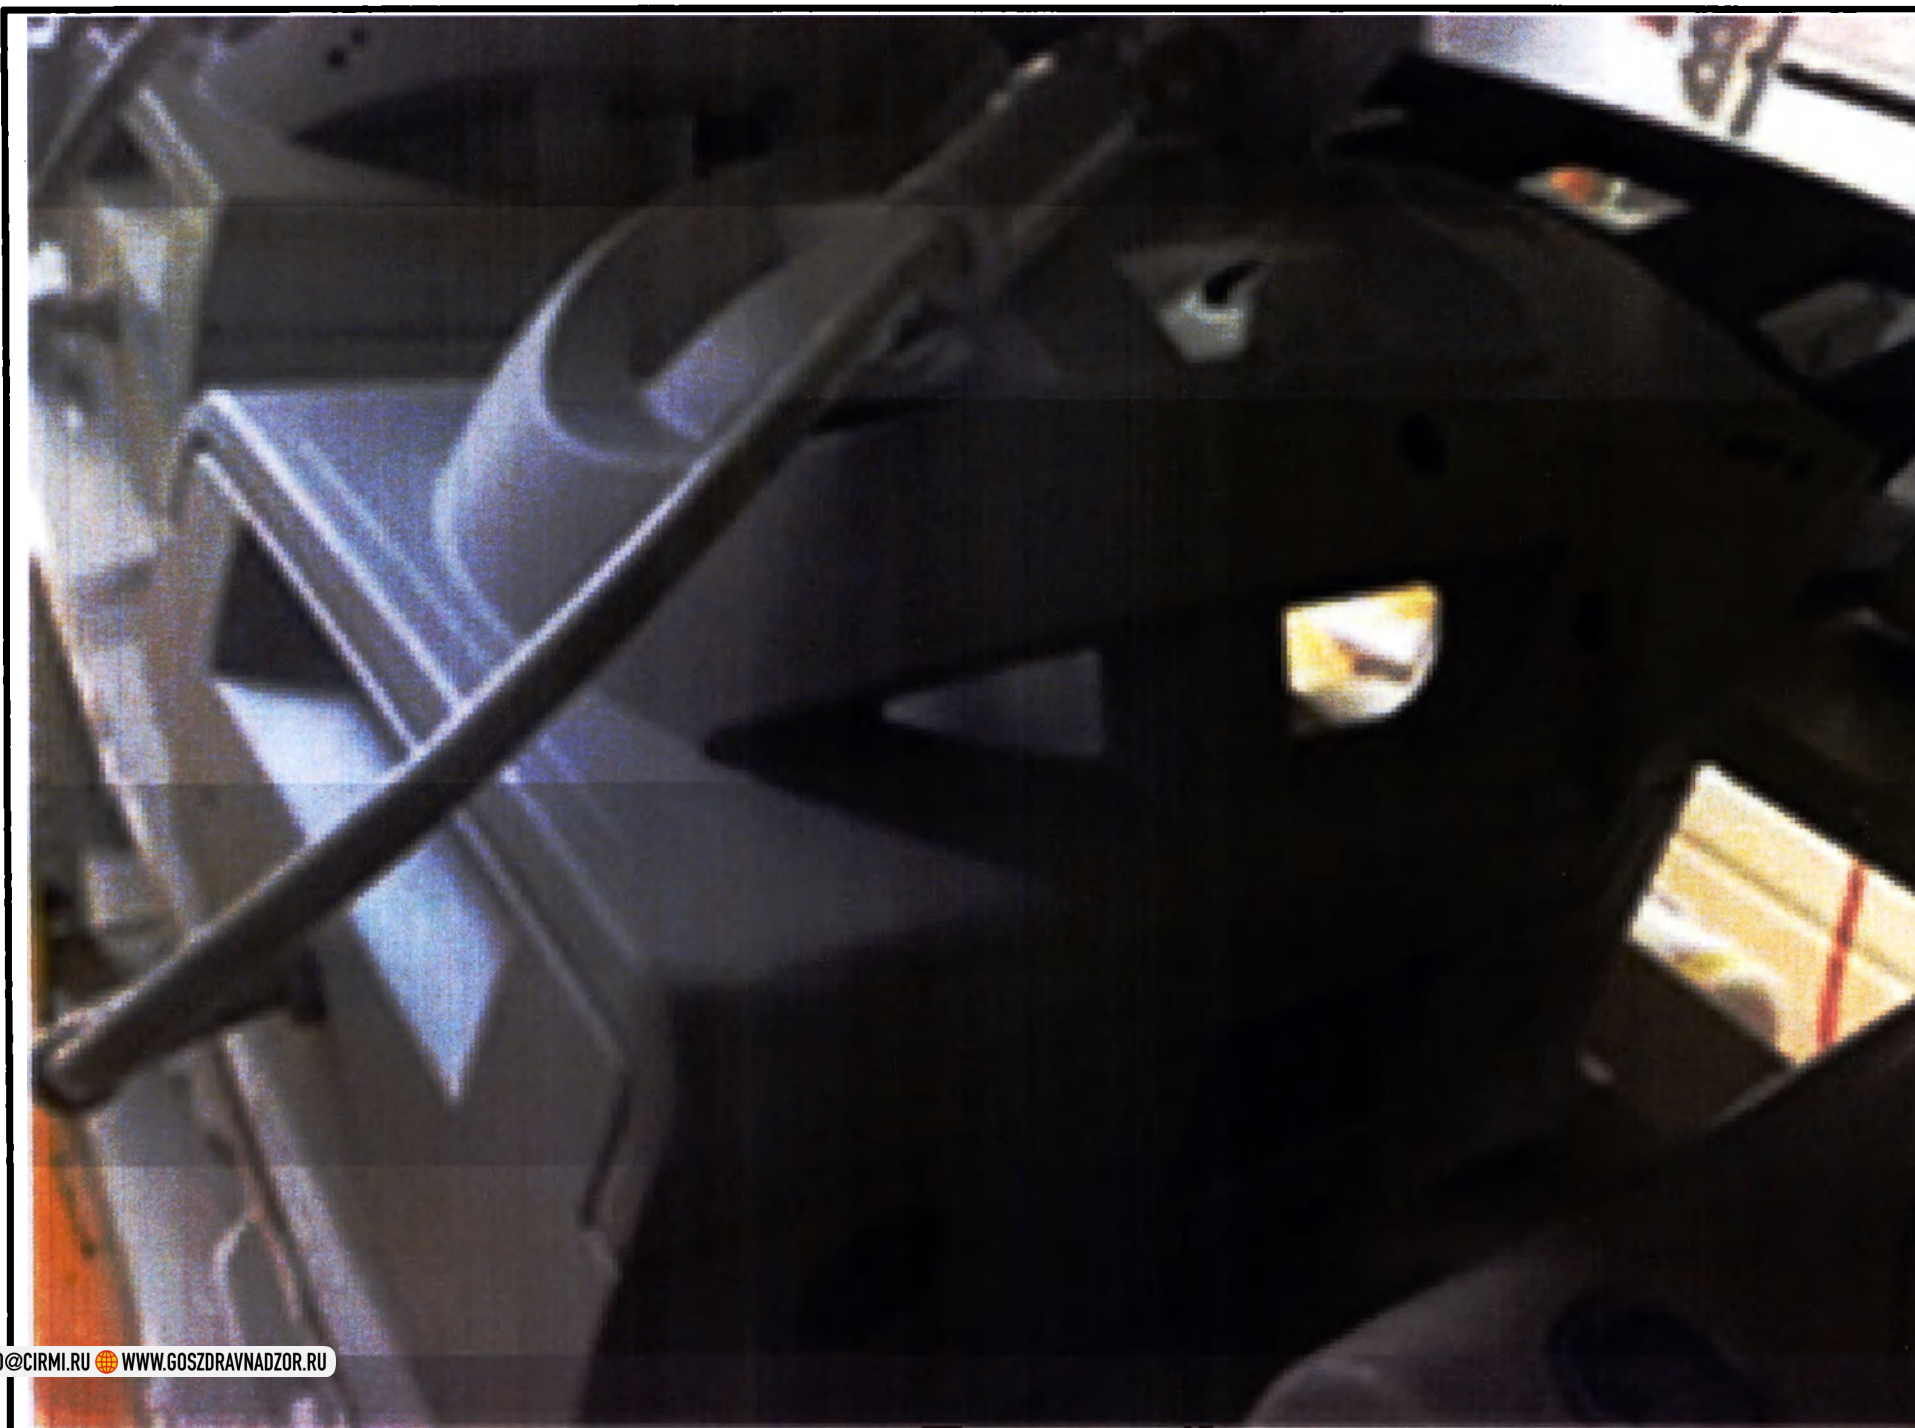

6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).

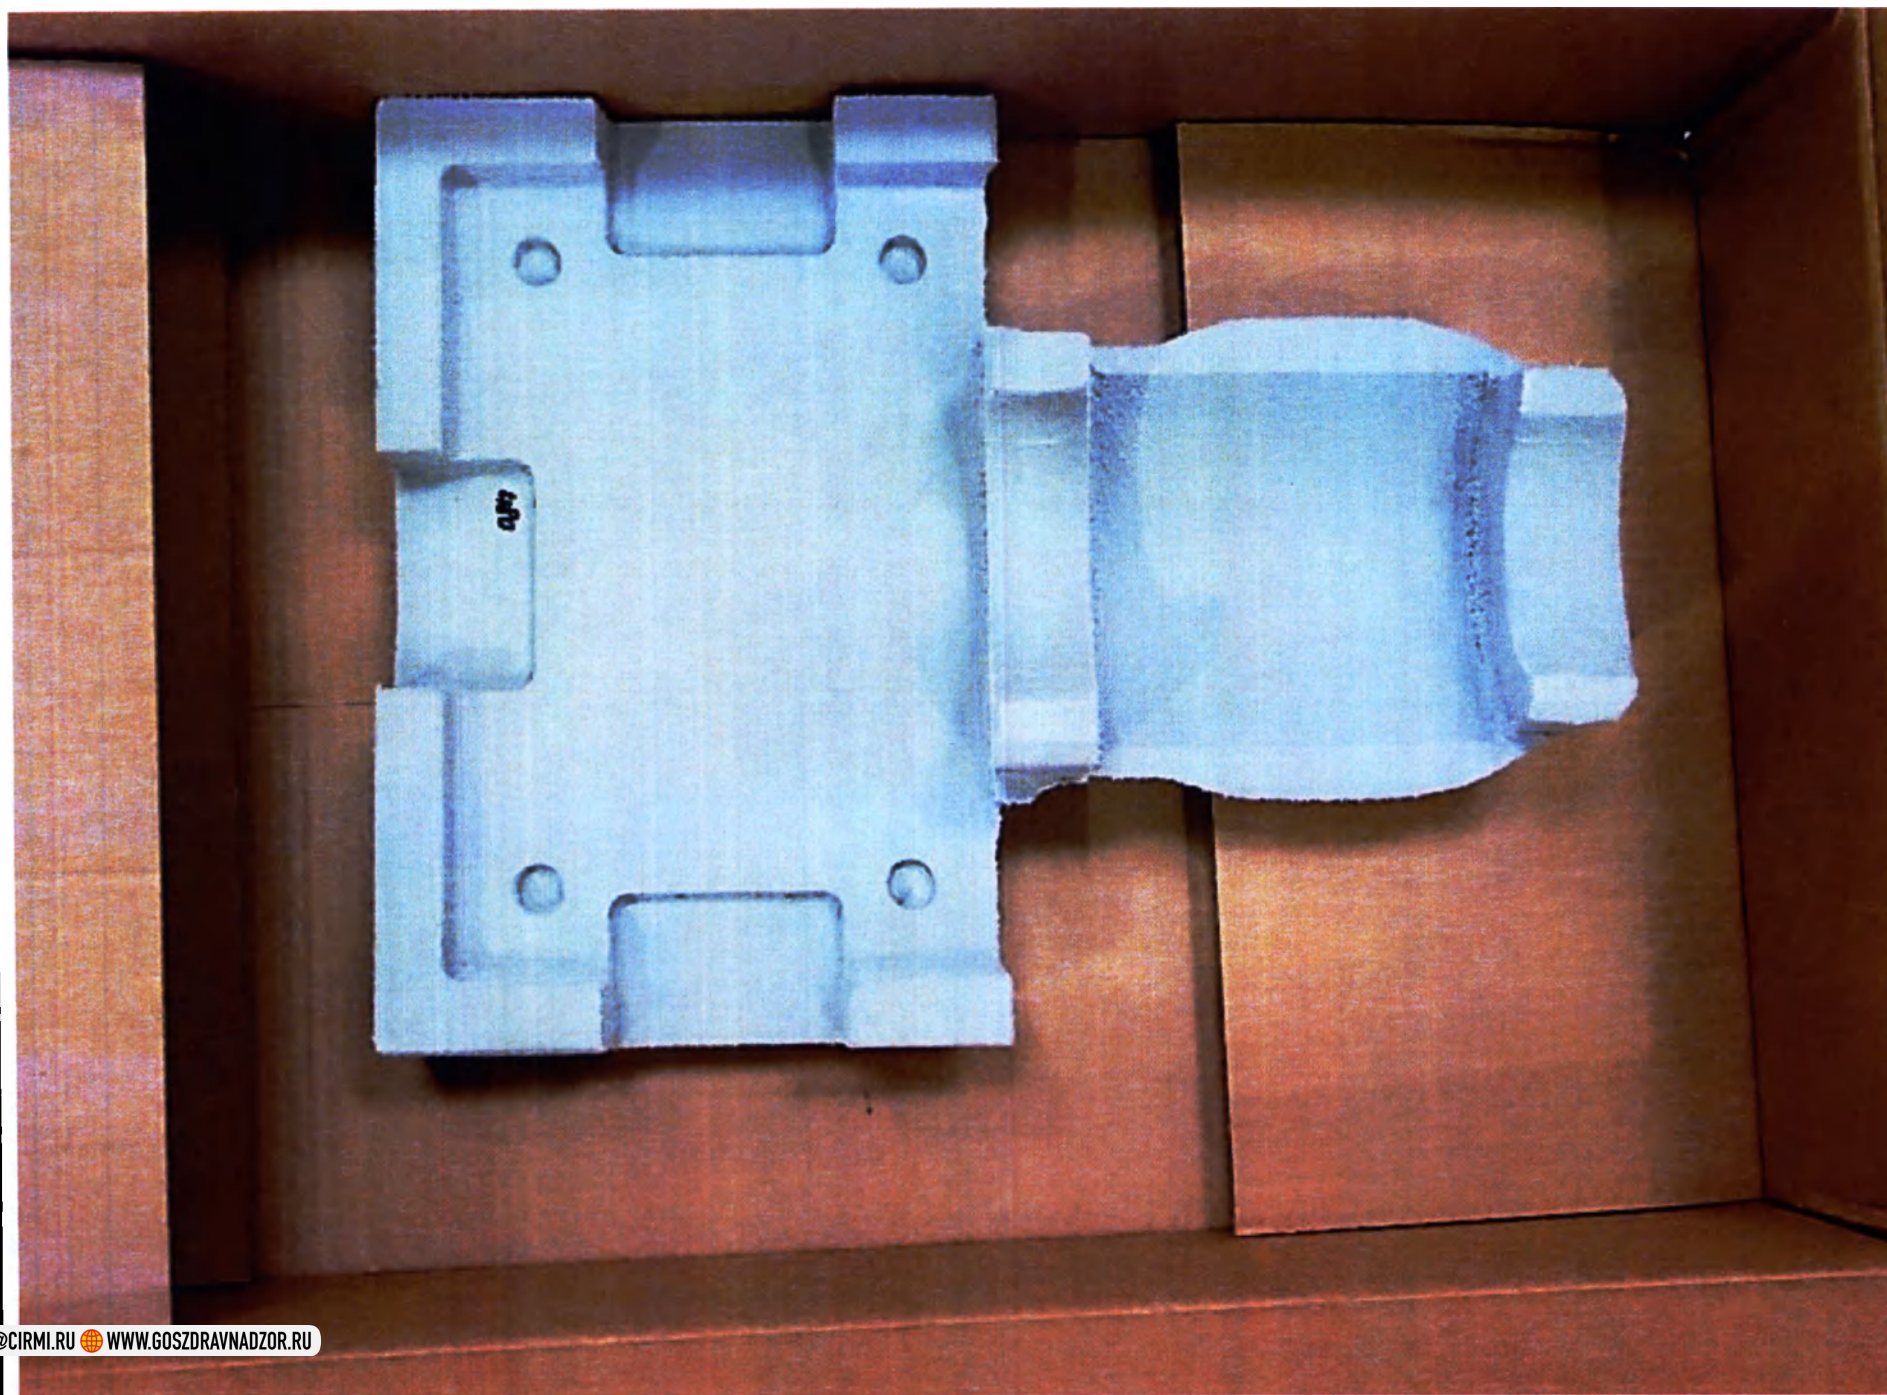


6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).



6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).



6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).

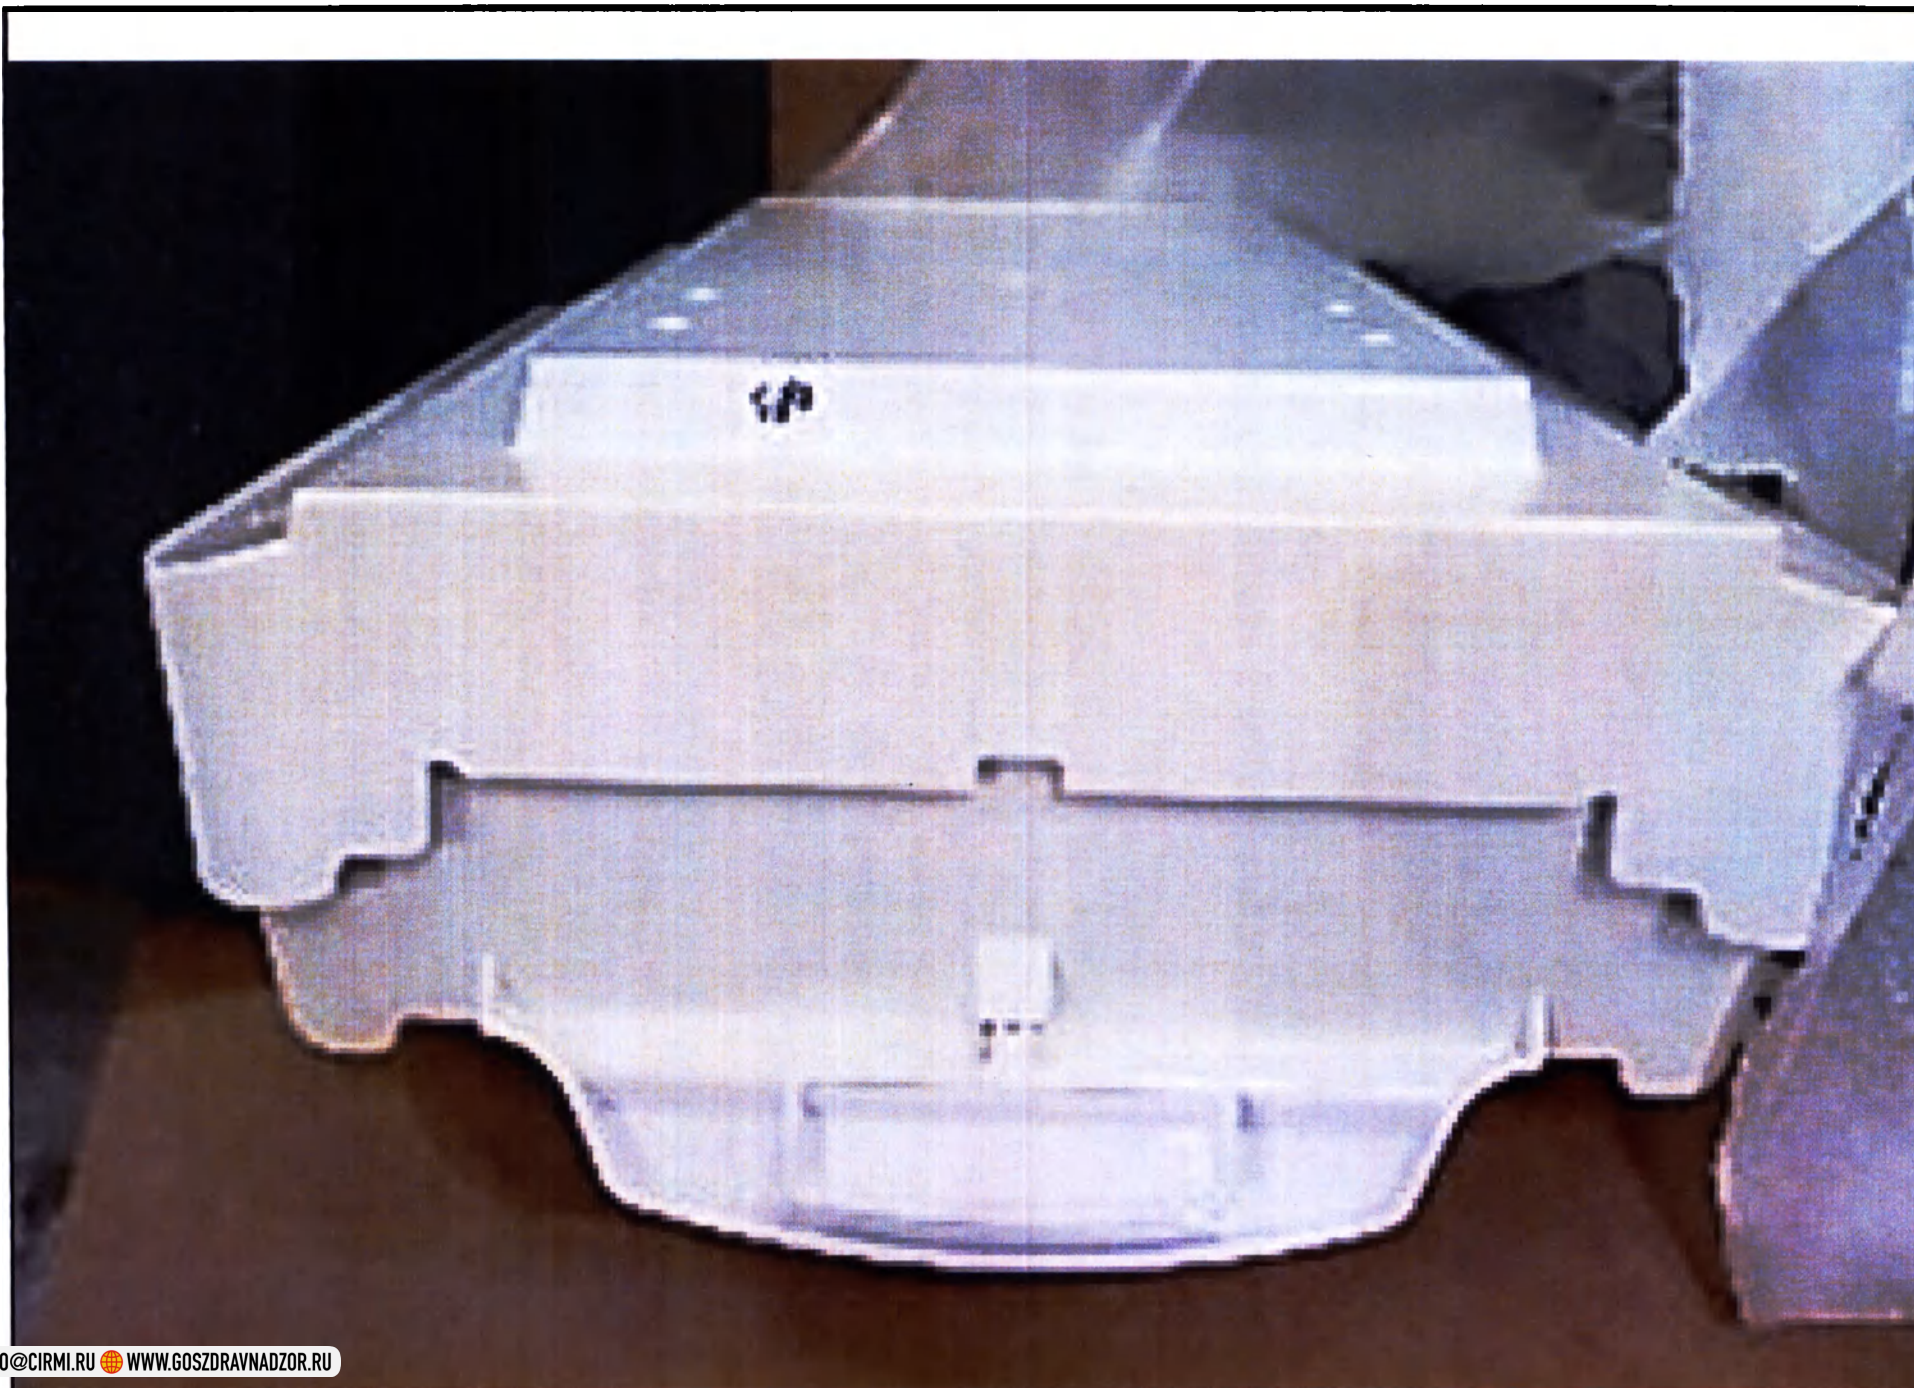


6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).




6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).




6. Катушки для исследования головы и шеи (не более 10 шт.).

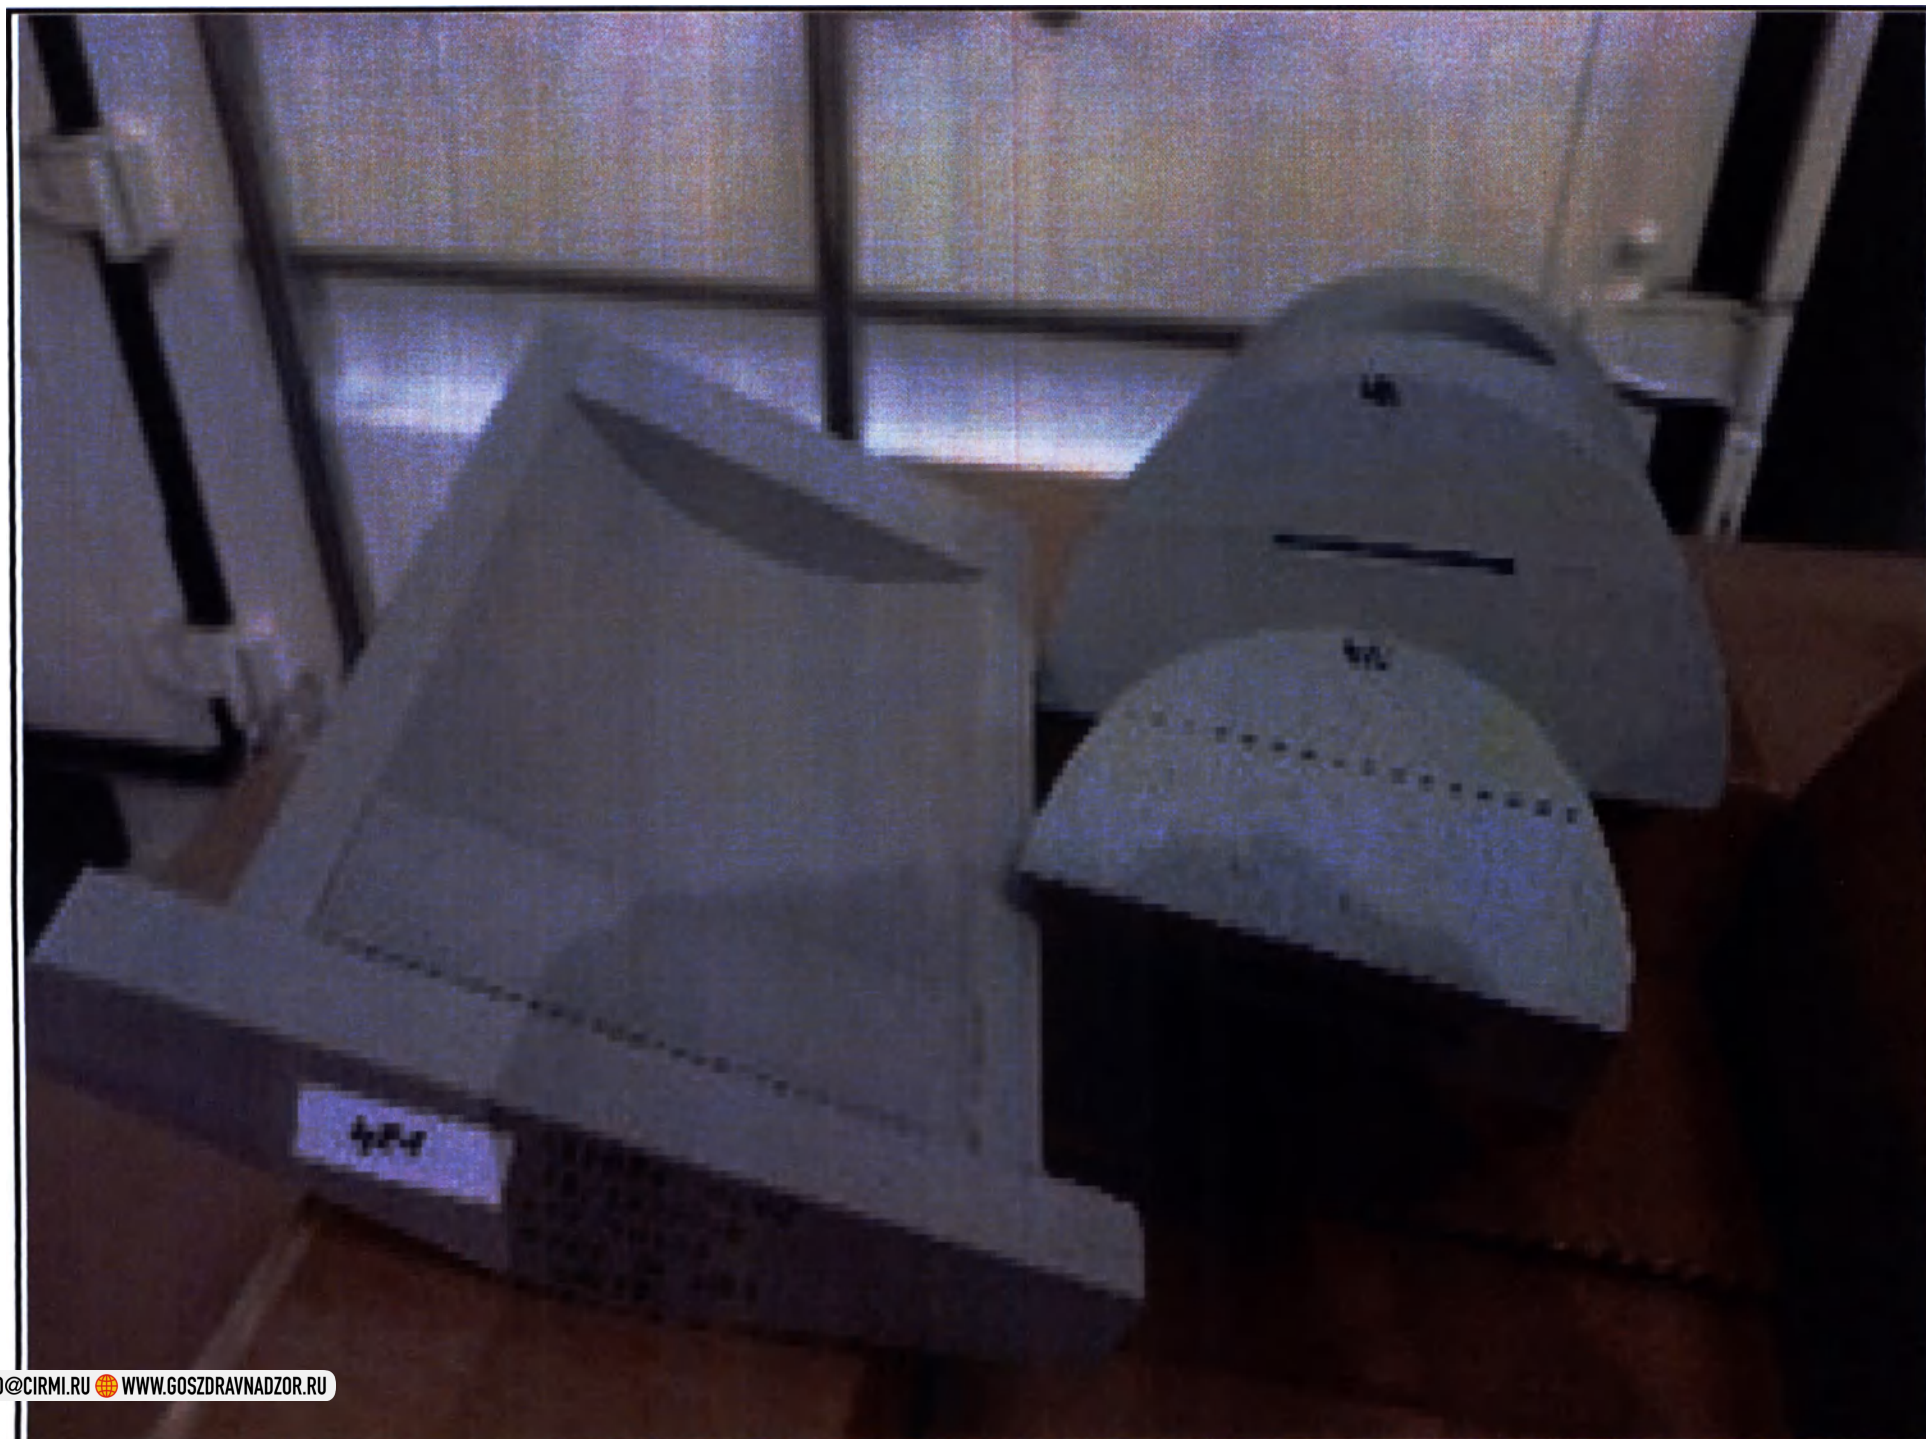


7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).

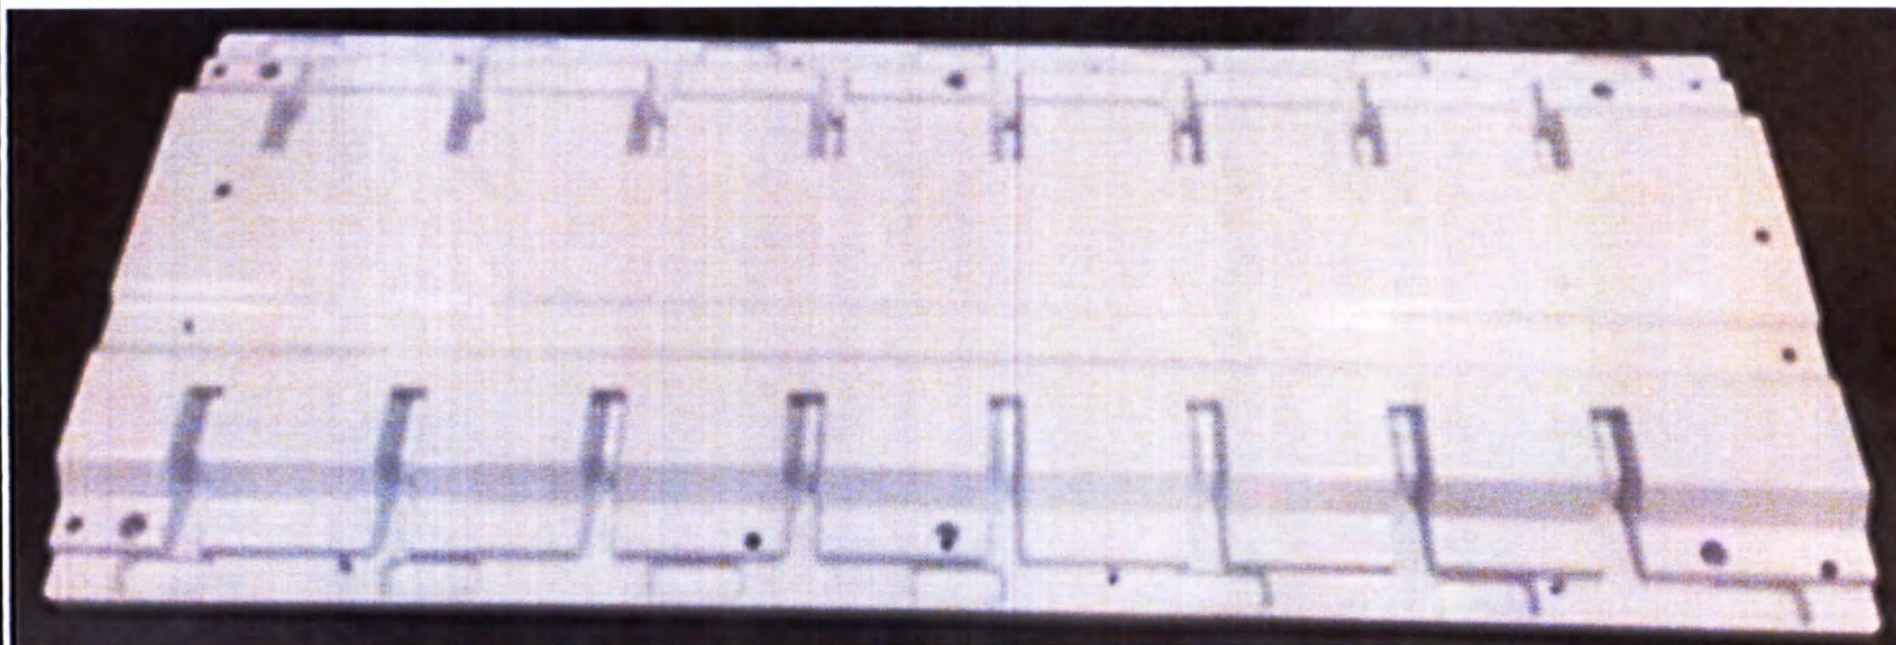

7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).

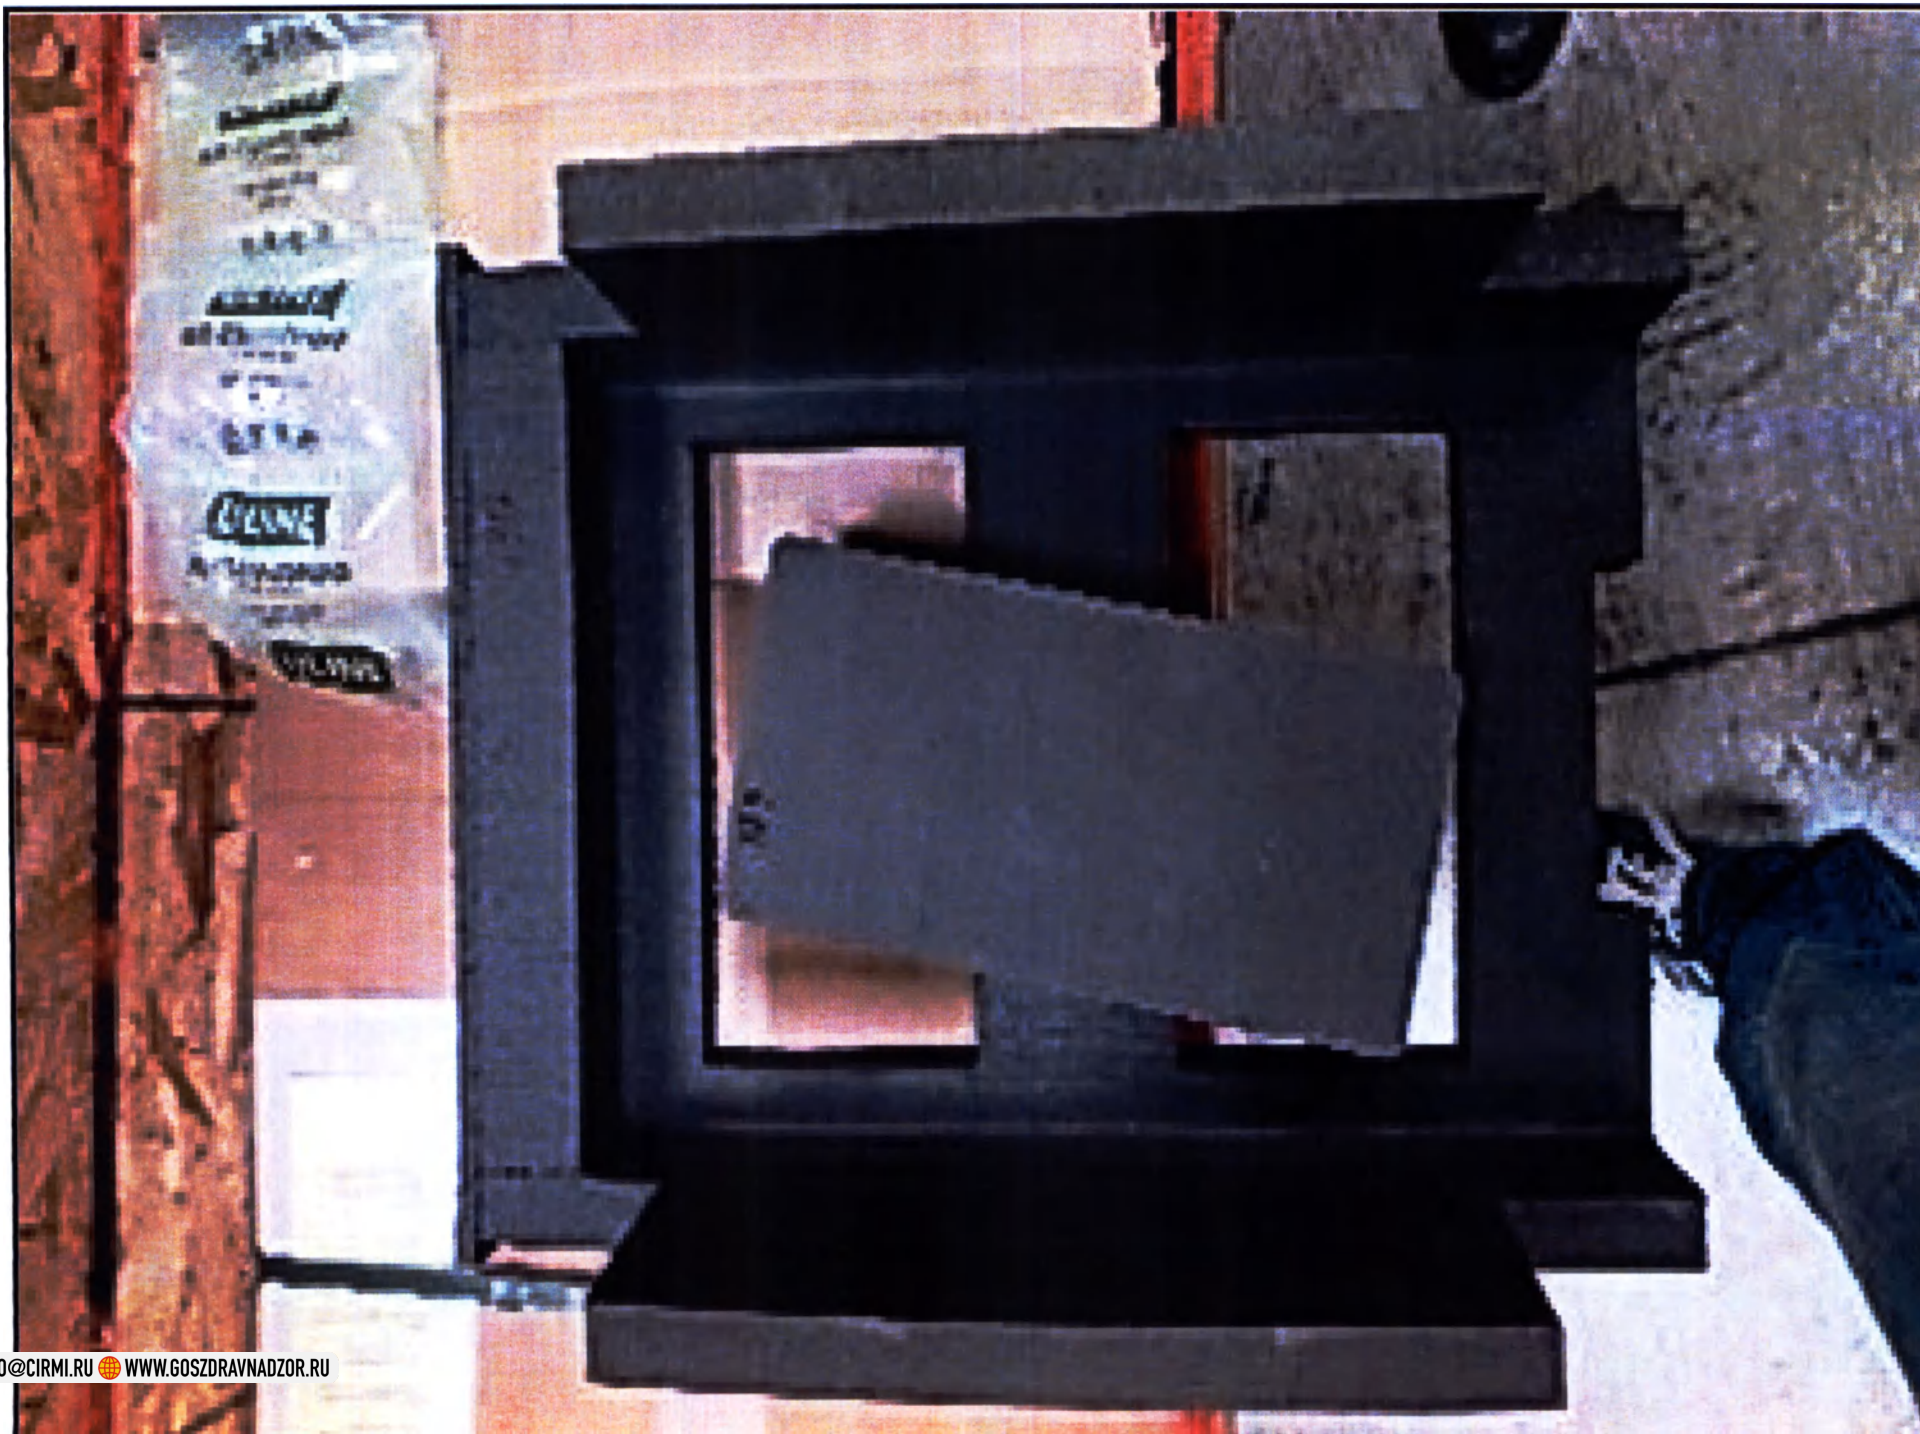

7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).

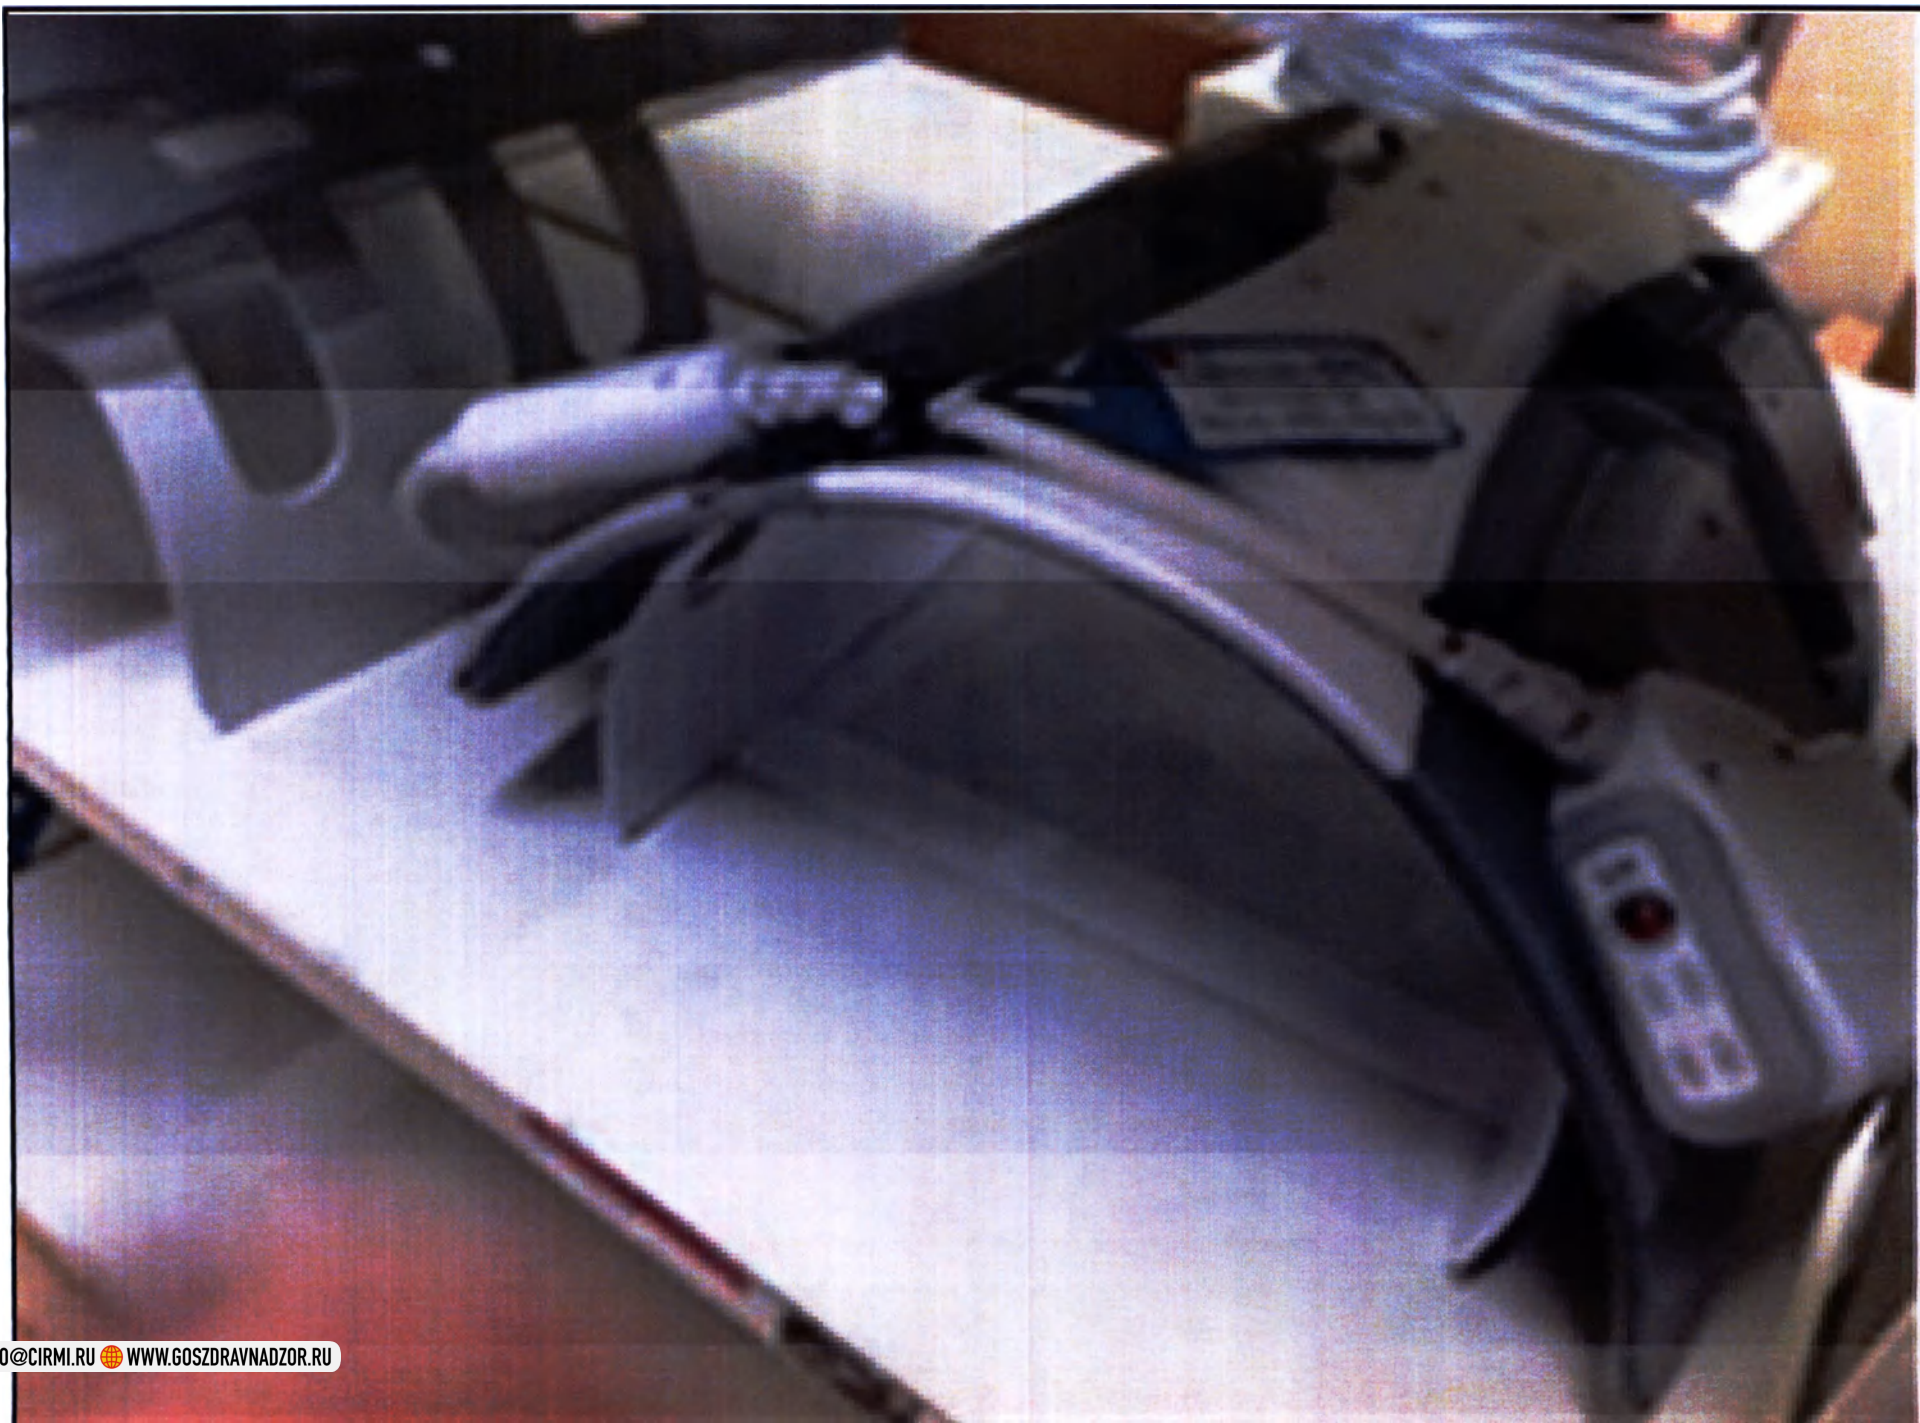

7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).




7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).



7. Поверхностные катушки (не более 10 шт.).



8. Катушки для исследования нижних конечностей (не более 10 шт.).

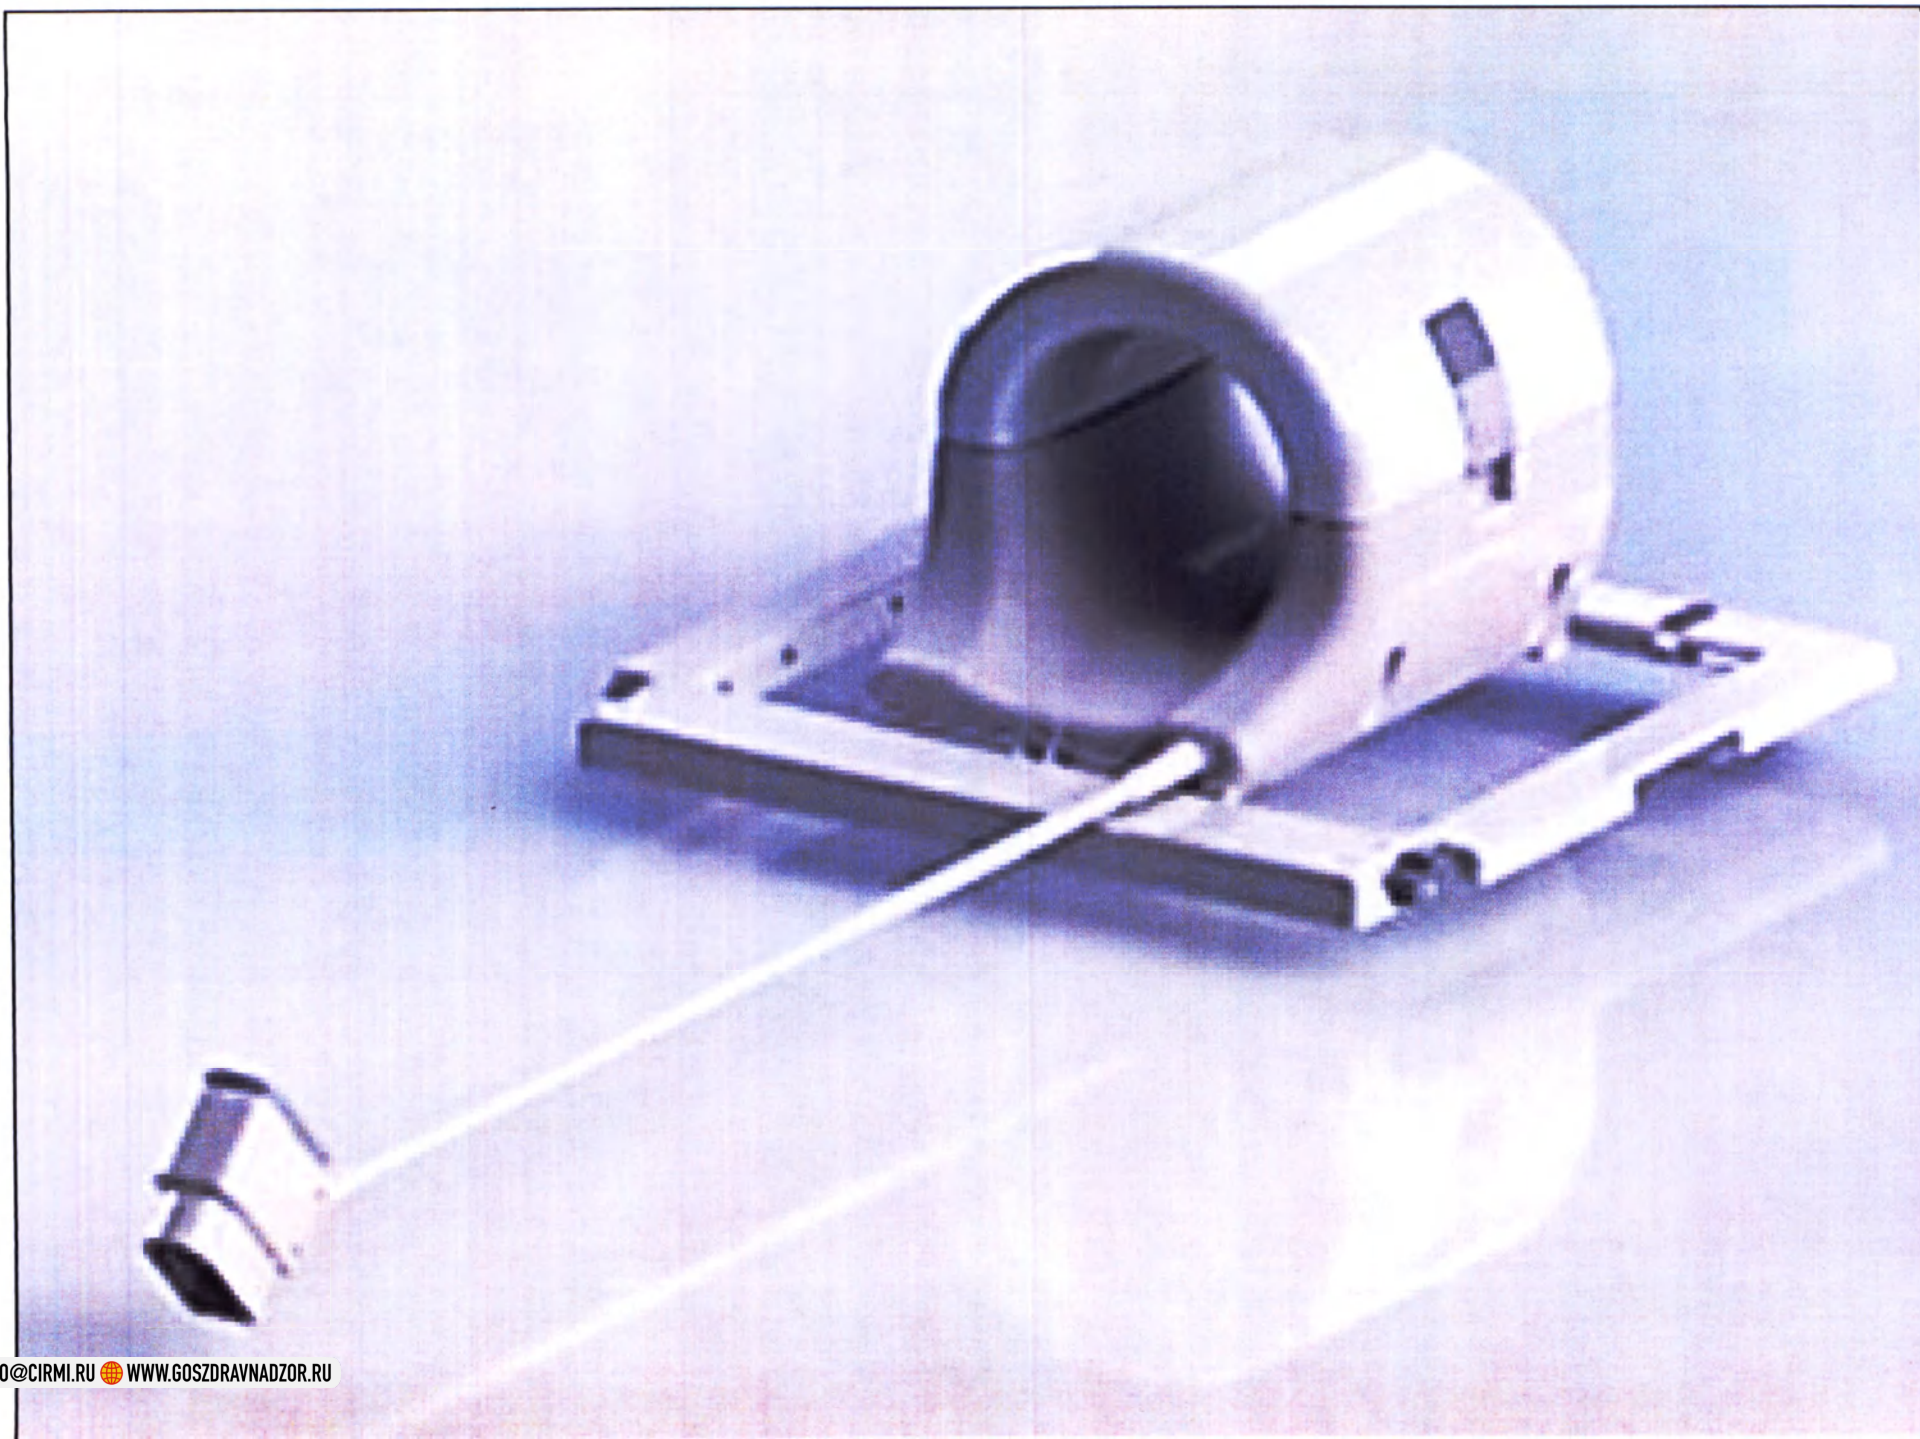

8. Катушки для исследования нижних конечностей (не более 10 шт.).



8. Катушки для исследования нижних конечностей (не более 10 шт.).



8. Катушки для исследования нижних конечностей (не более 10 шт.).




9. Катушки для исследования верхних конечностей (не более 10 шт.).




9. Катушки для исследования верхних конечностей (не более 10 шт.).




9. Катушки для исследования верхних конечностей (не более 10 шт.).

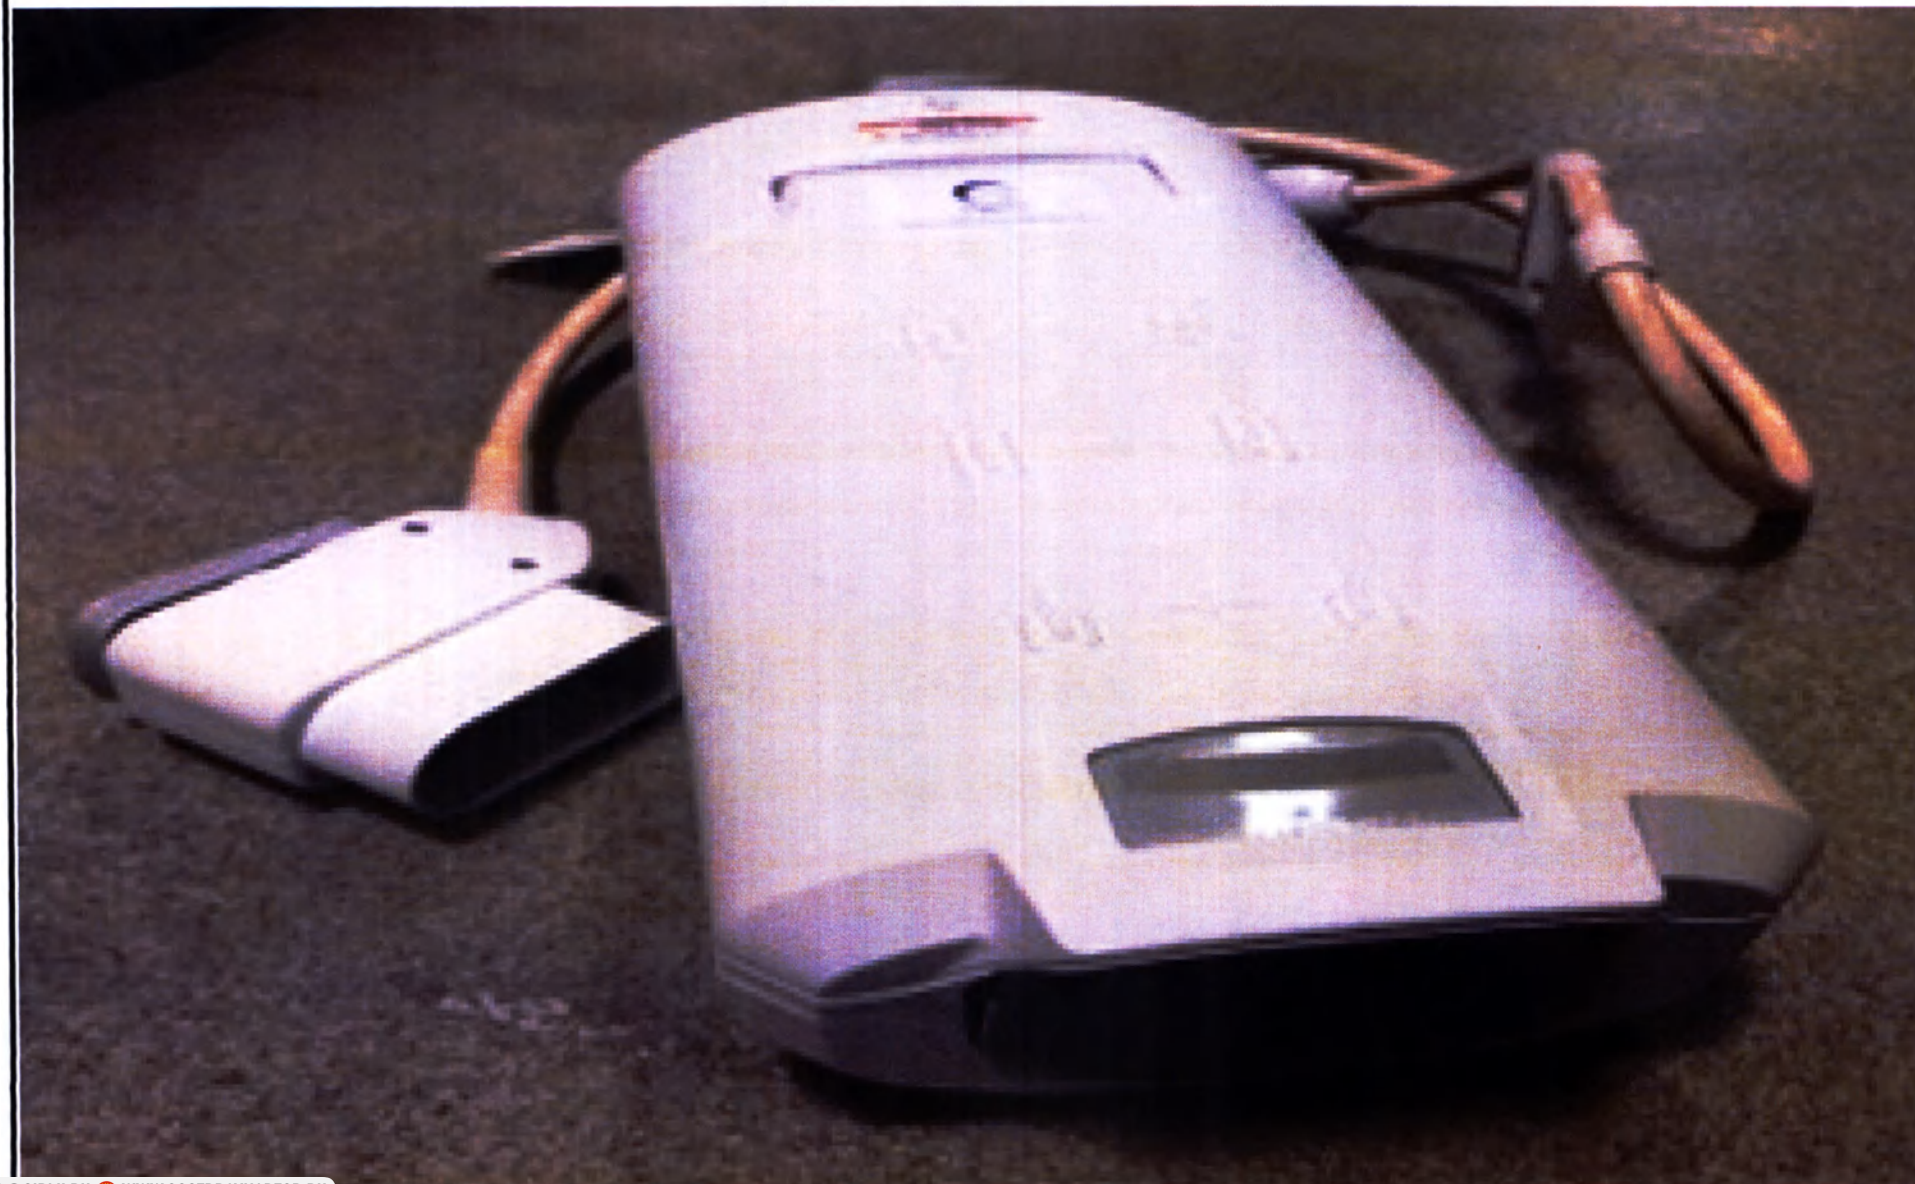

9. Катушки для исследования верхних конечностей (не более 10 шт.).

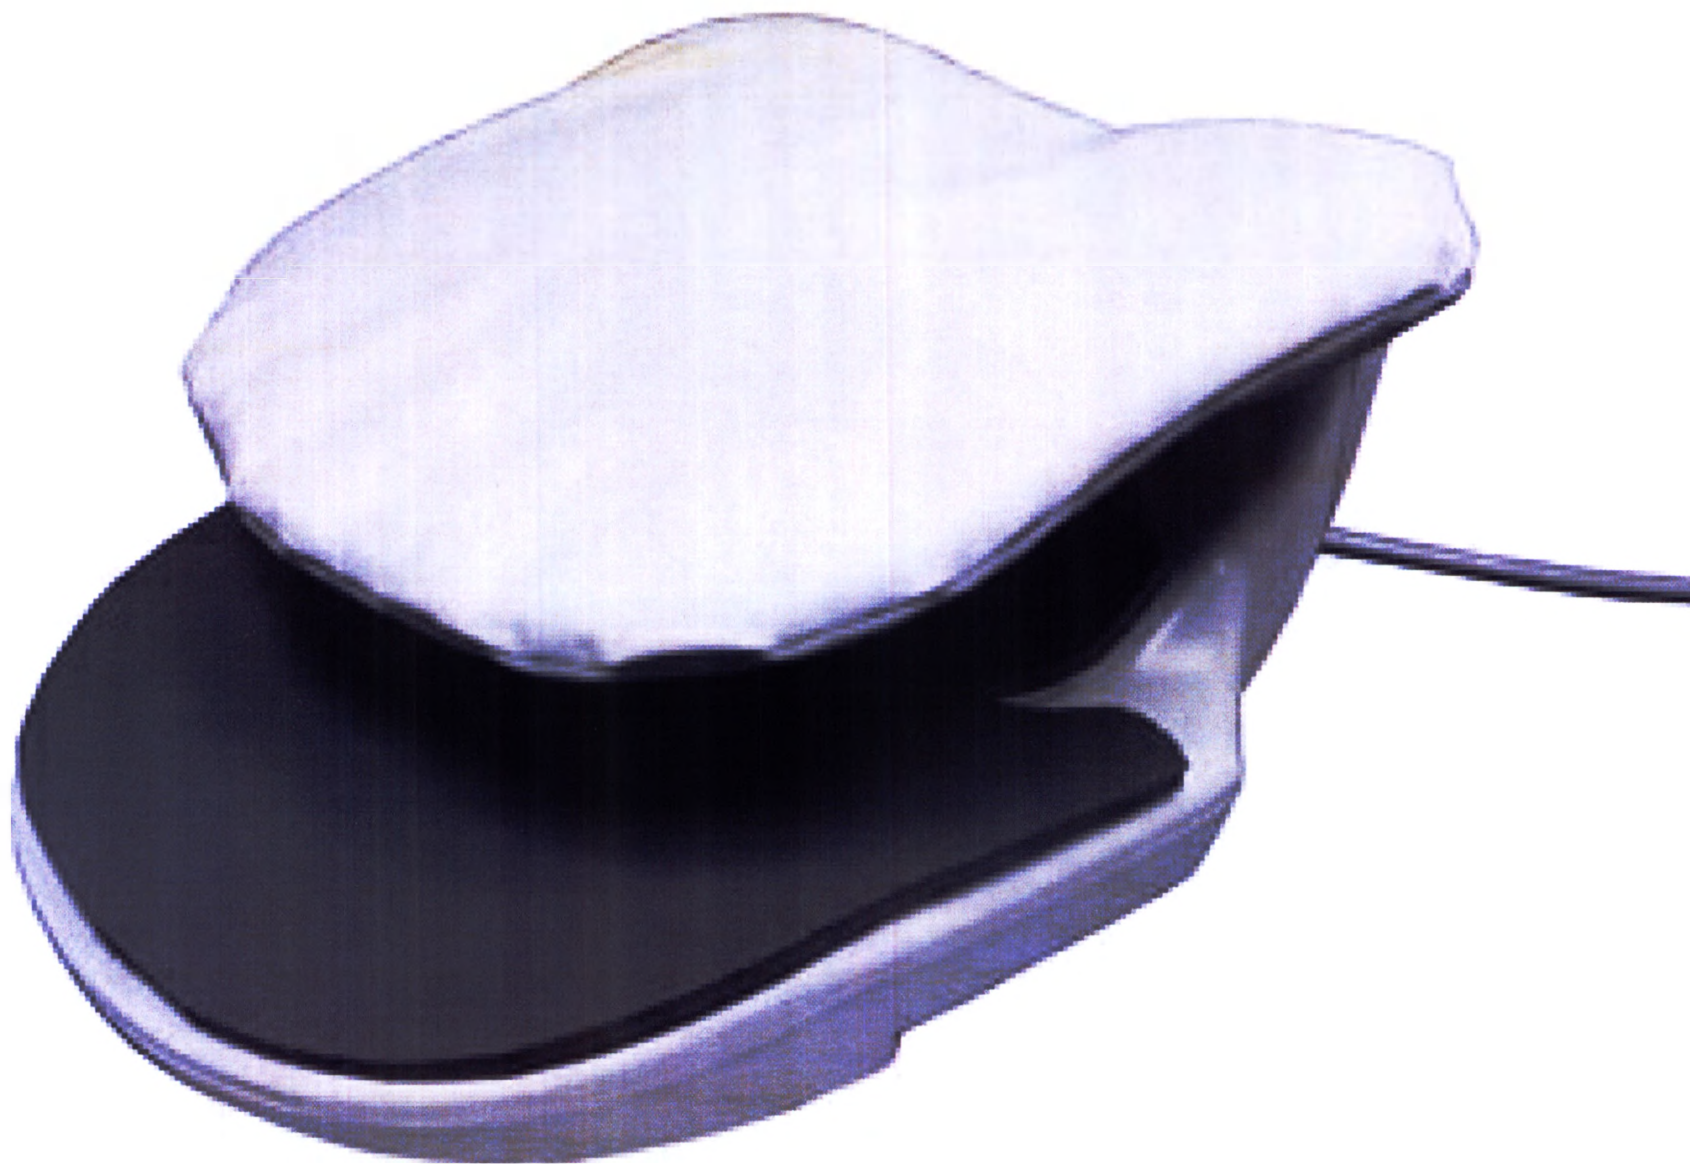


9. Катушки для исследования верхних конечностей (не более 10 шт.).

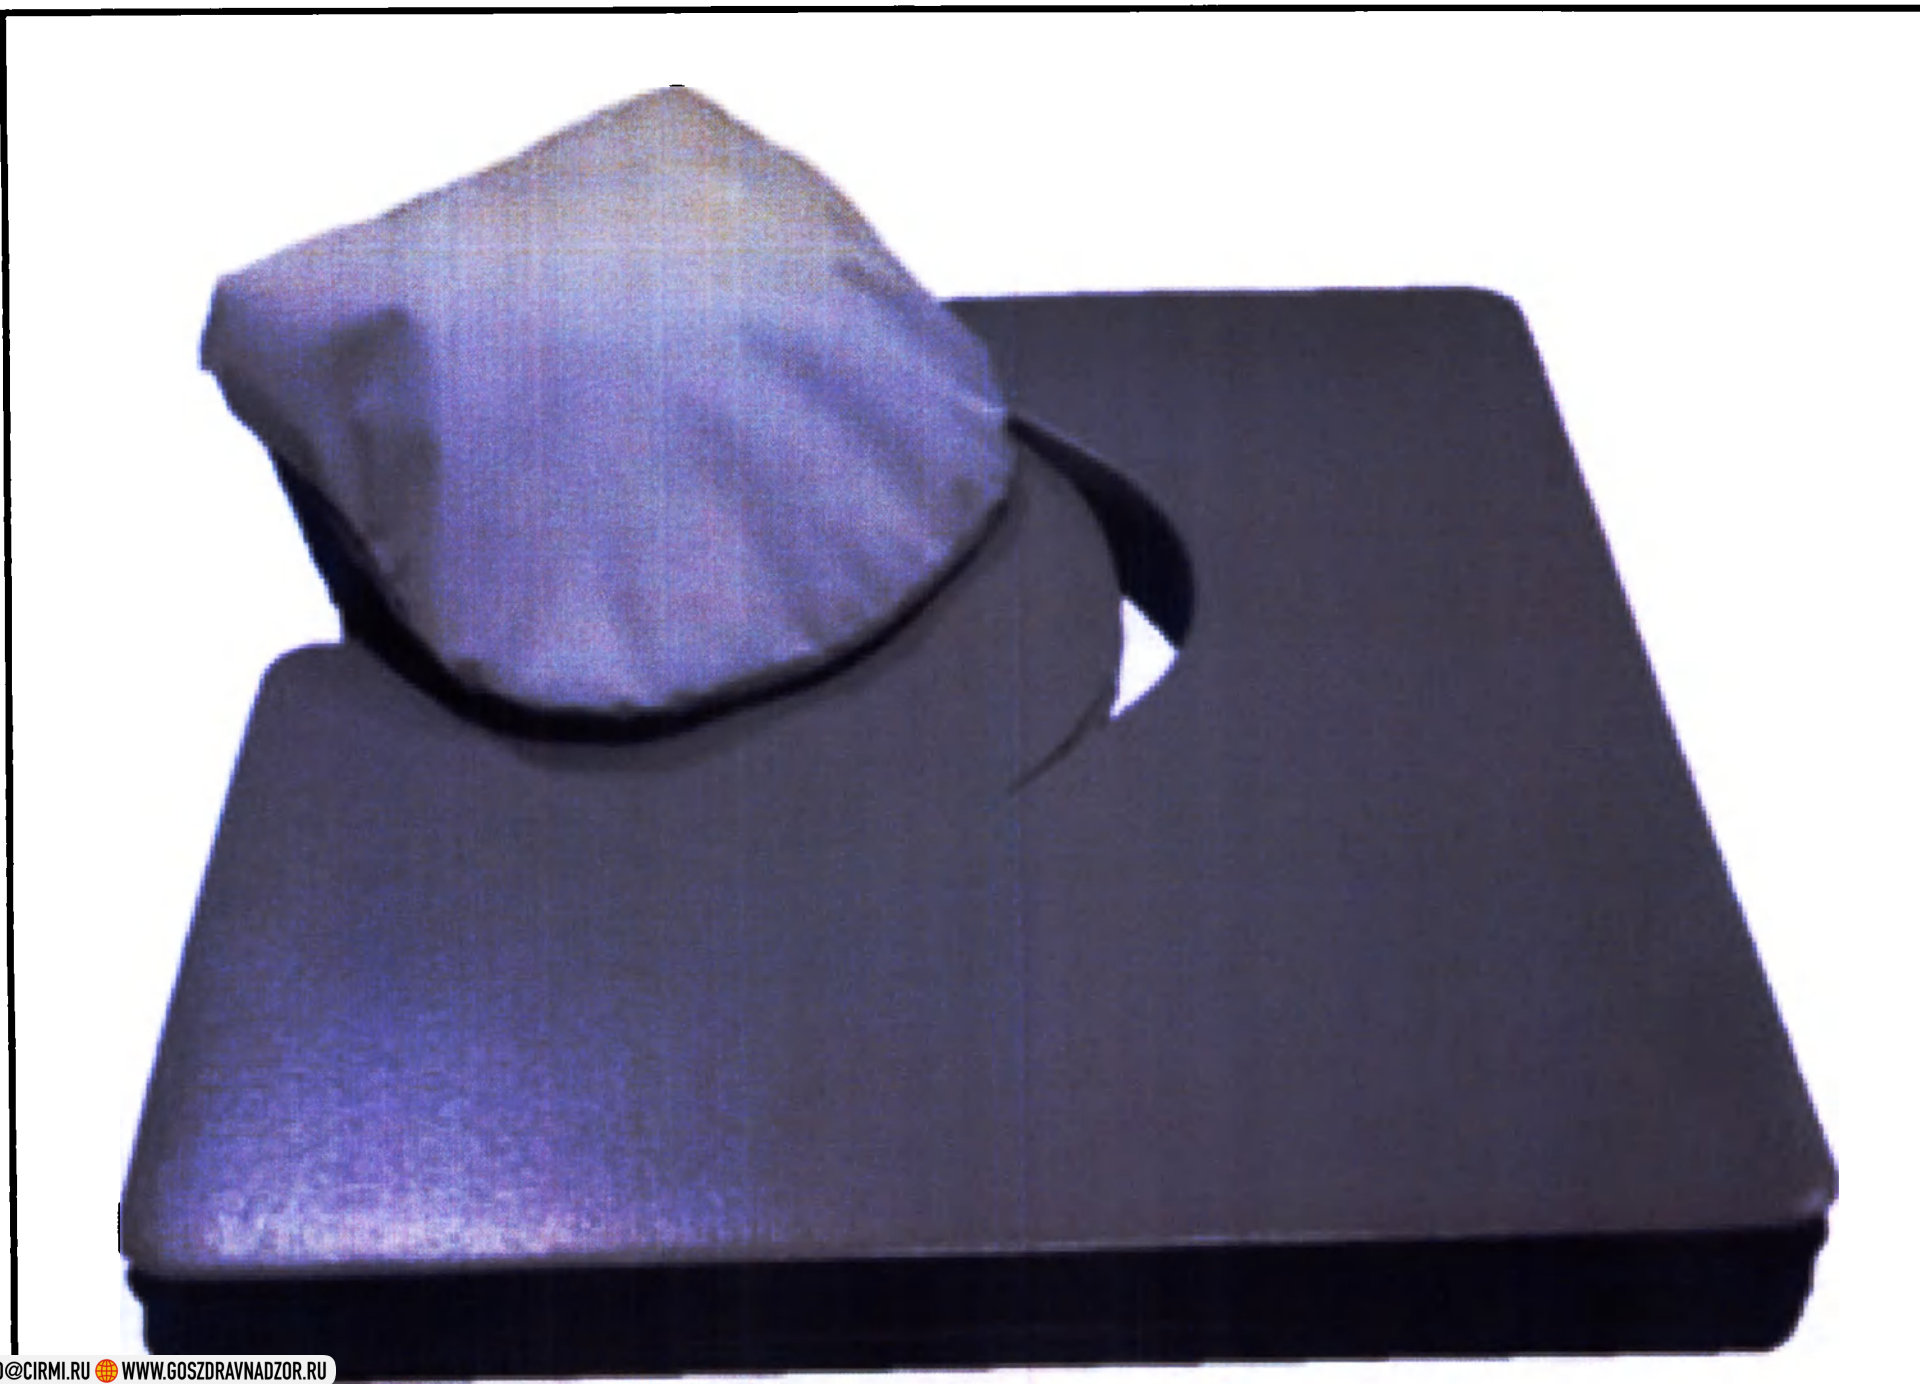

10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).




10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

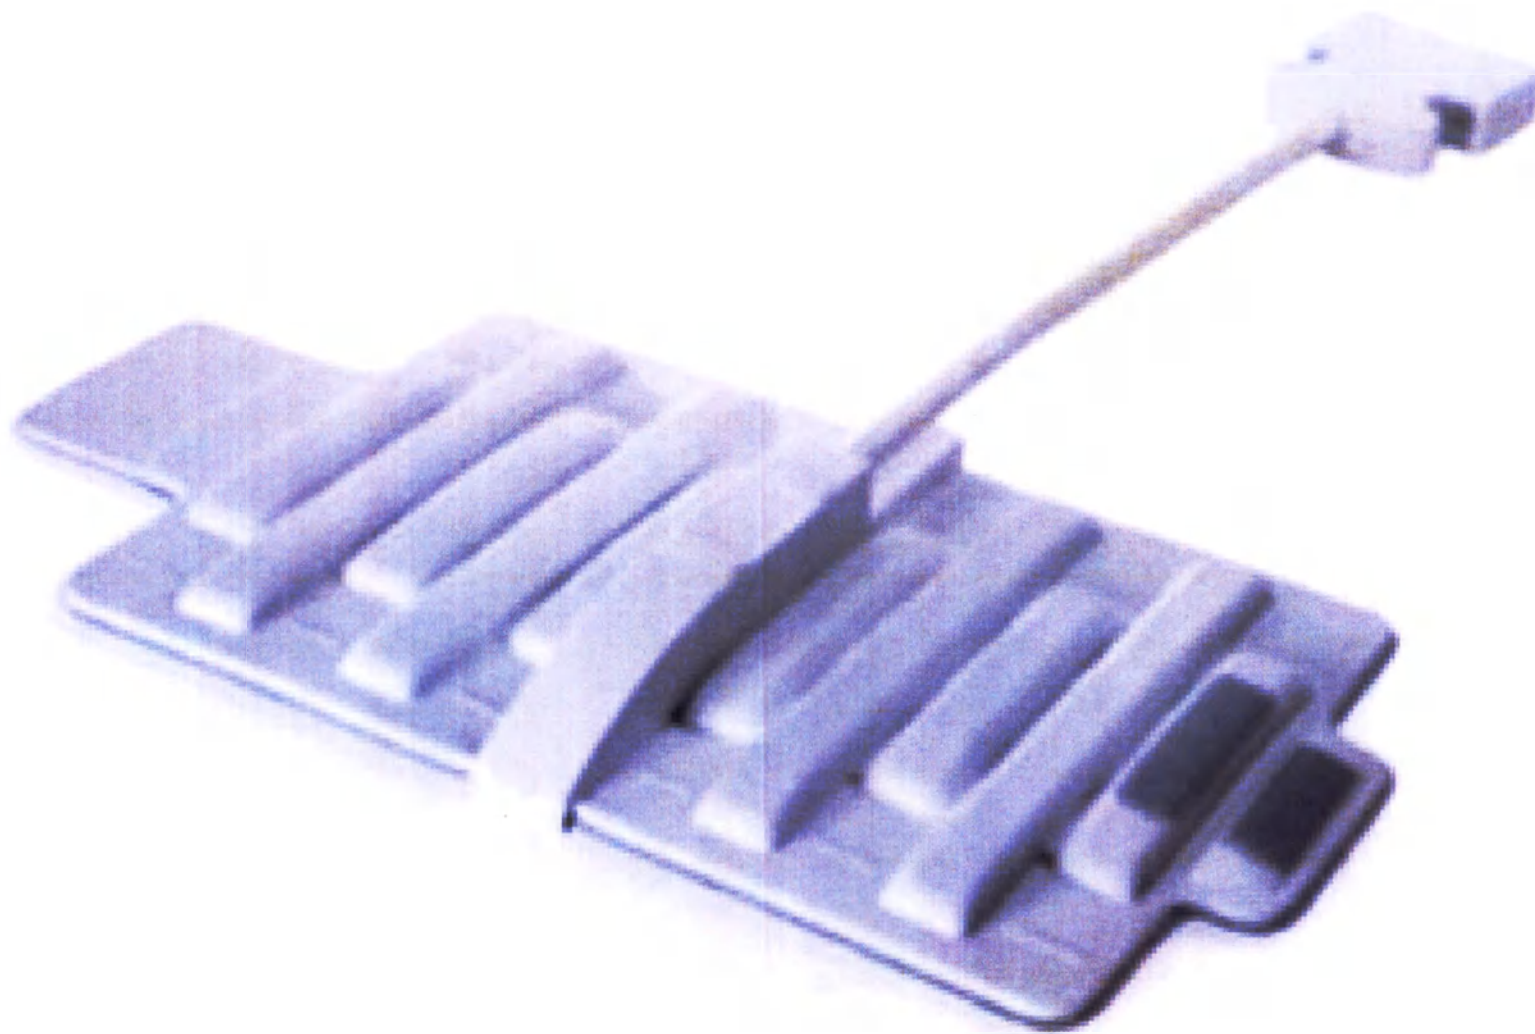


10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).



10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

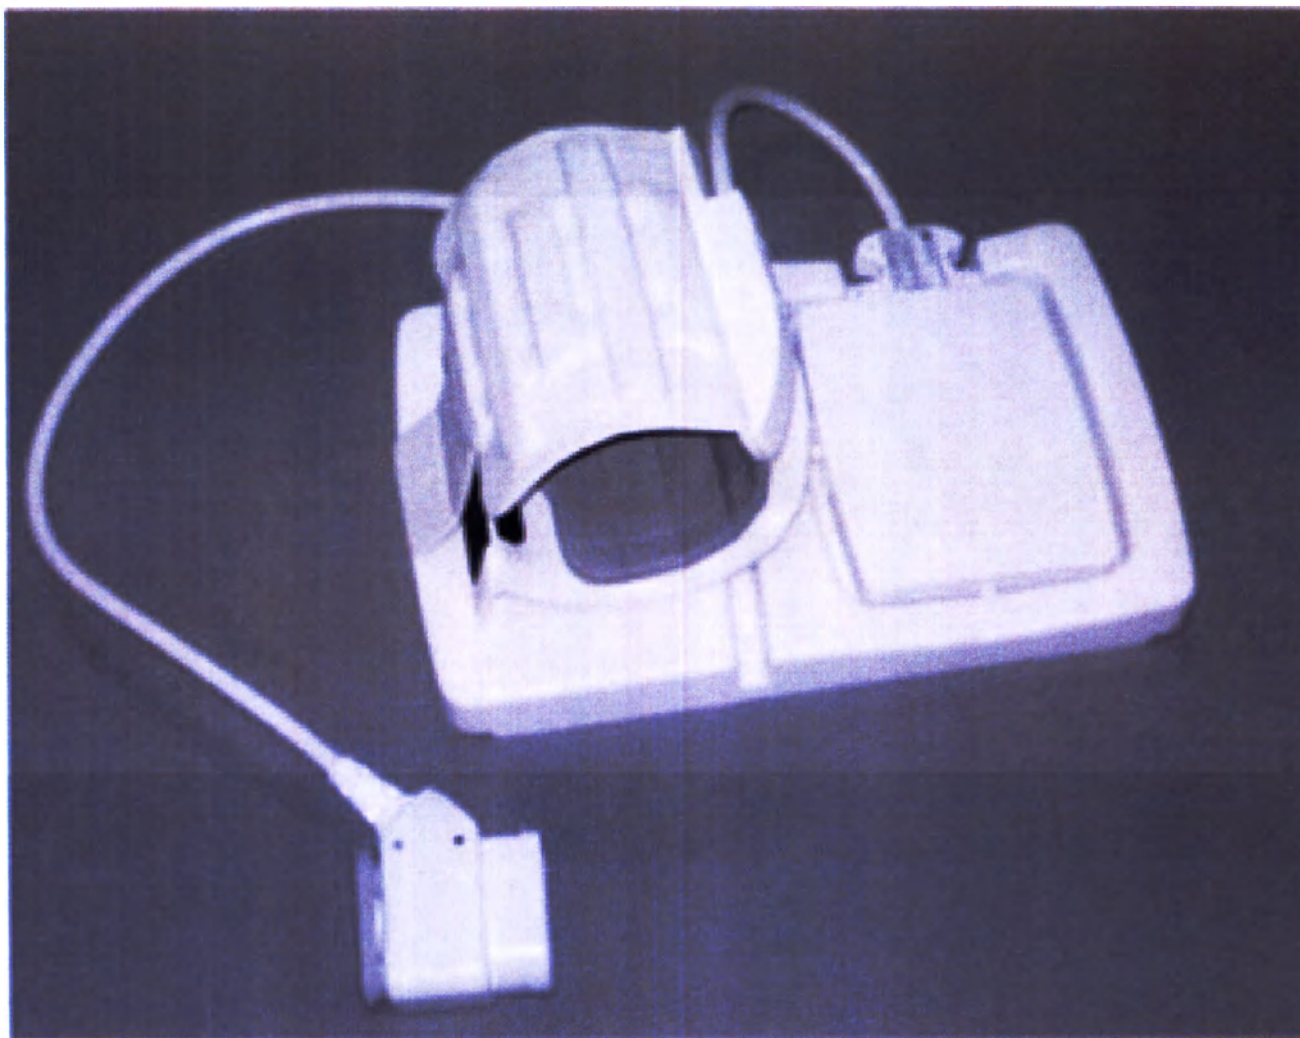

10. Катушки гибкие для исследований (не более 5 шт.).

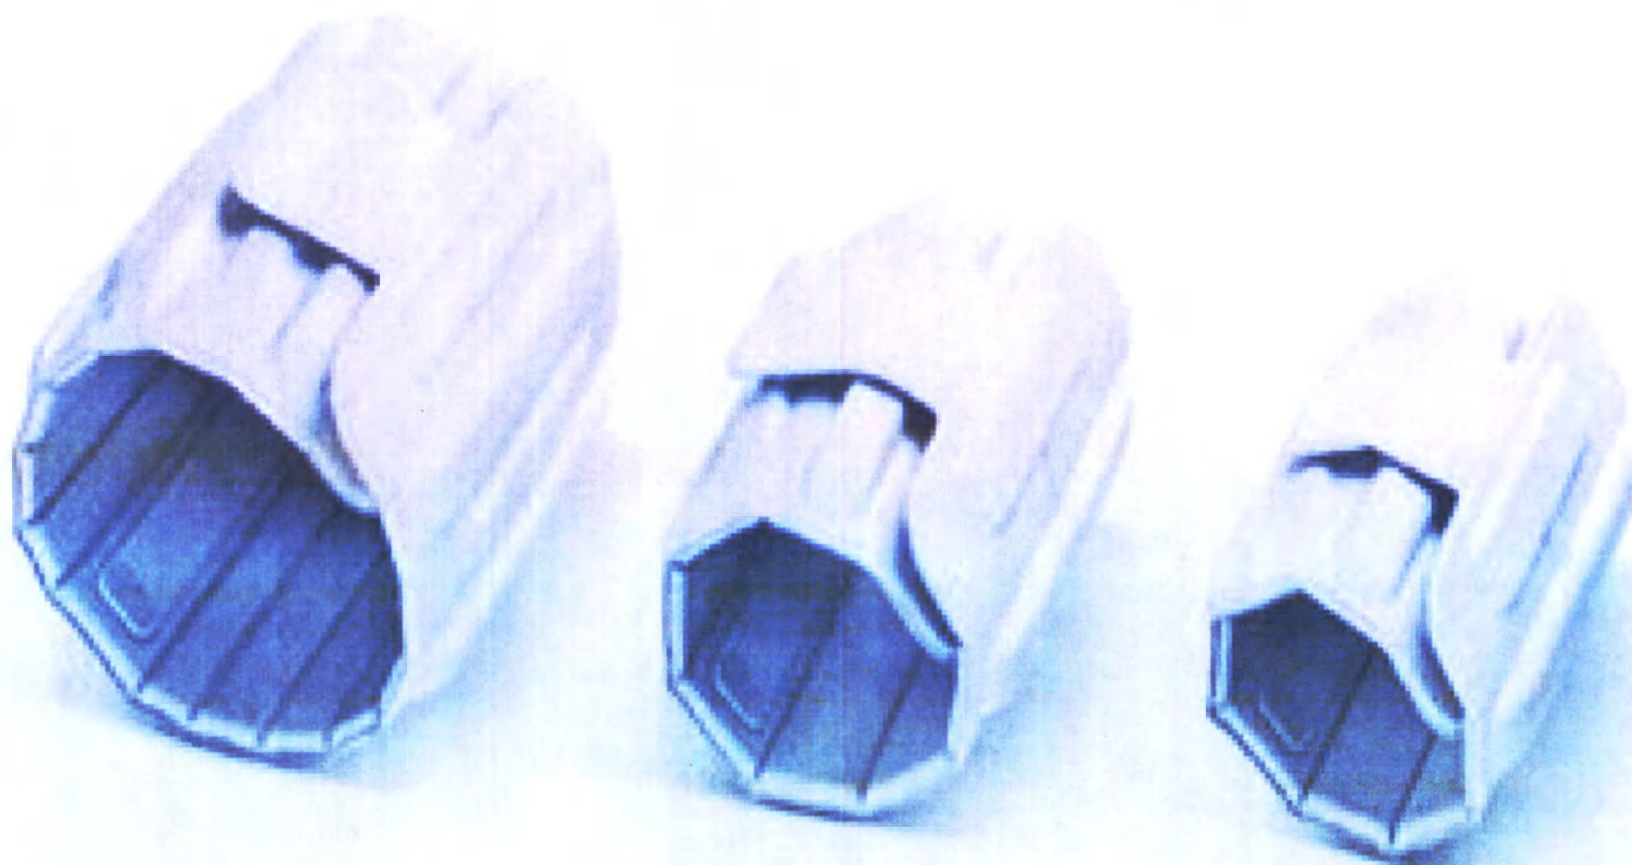

11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).



11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).




11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).




11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).




11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).

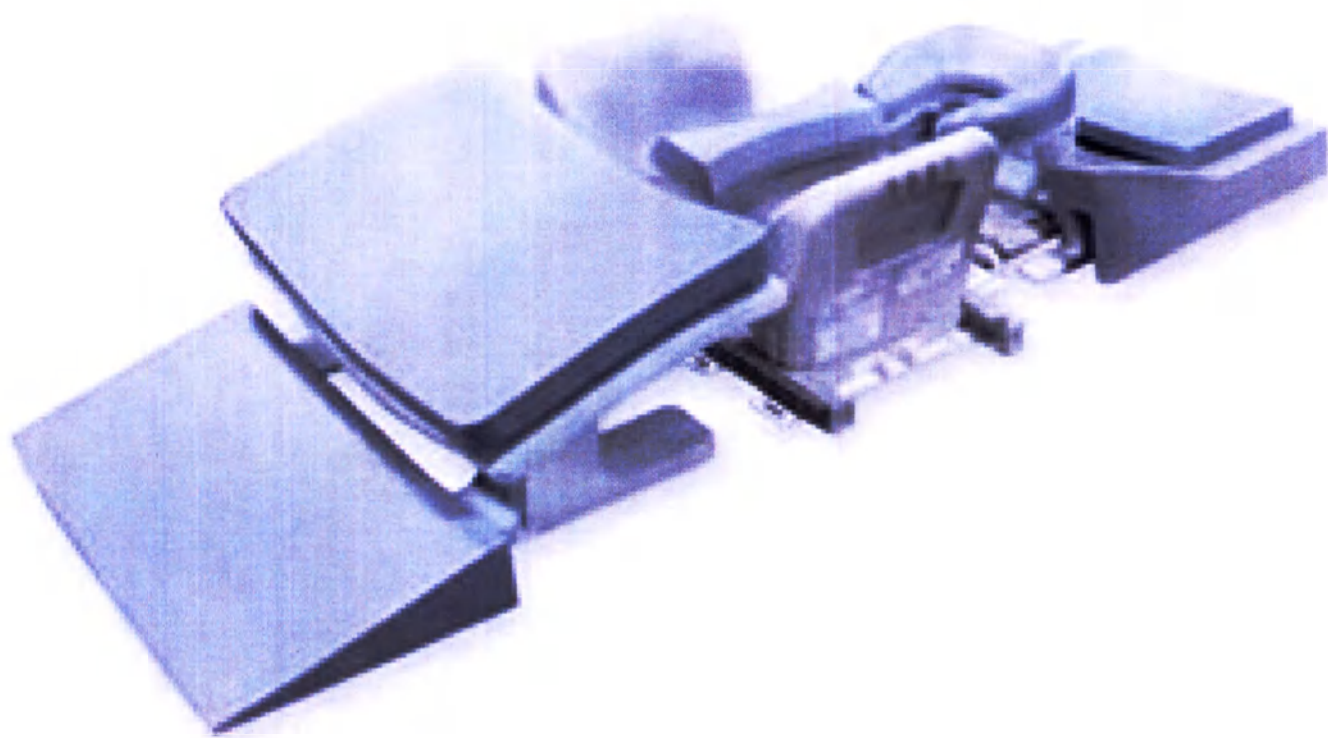


11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).

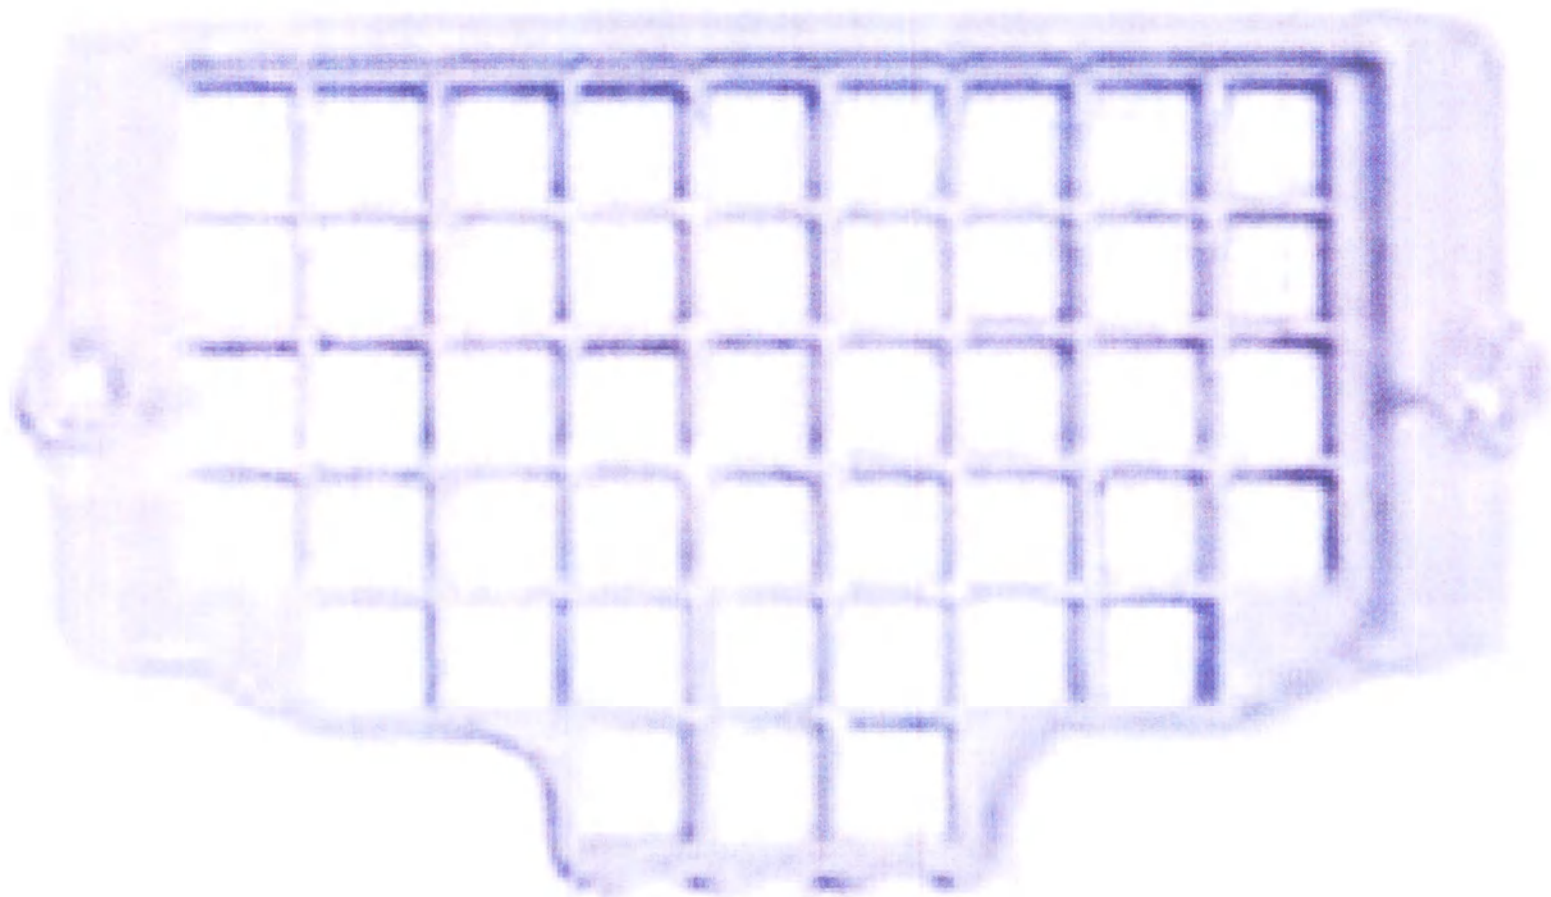

11. Катушки для исследования молочных желез, варианты исполнения: 8-канальная, 16-канальная (не более 5 шт.).

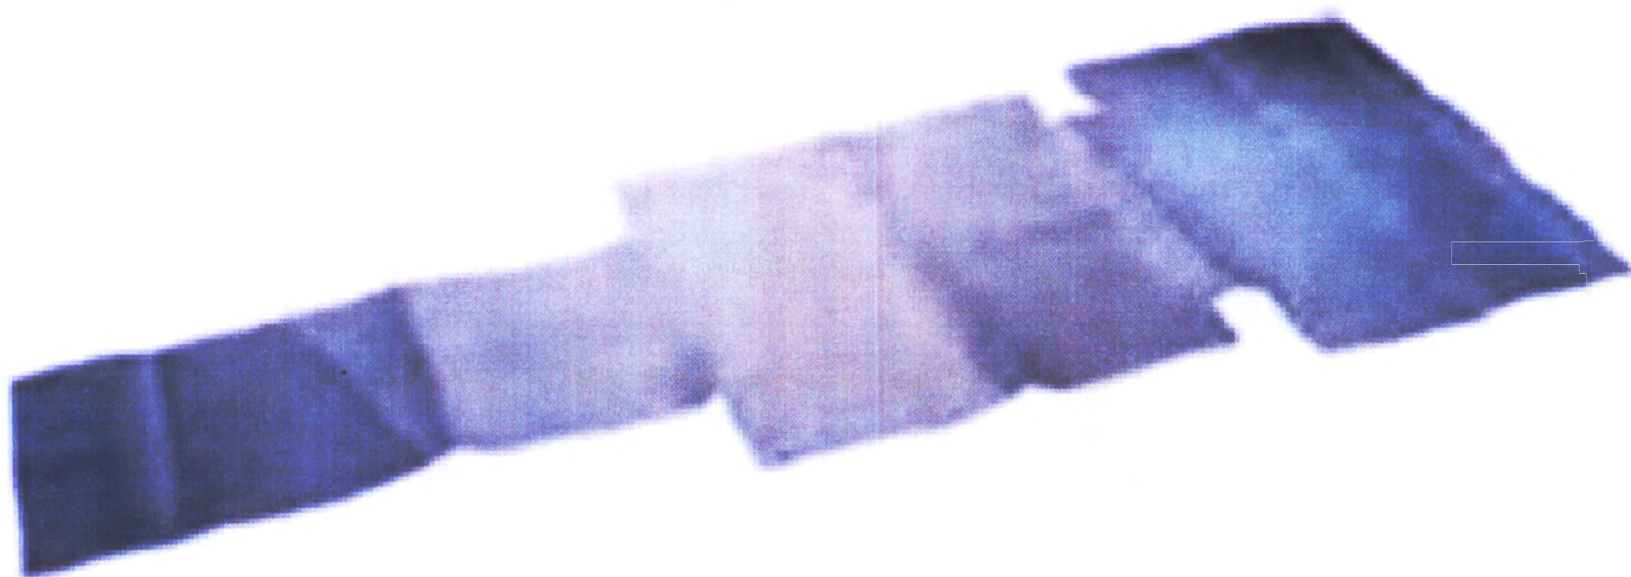


12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).

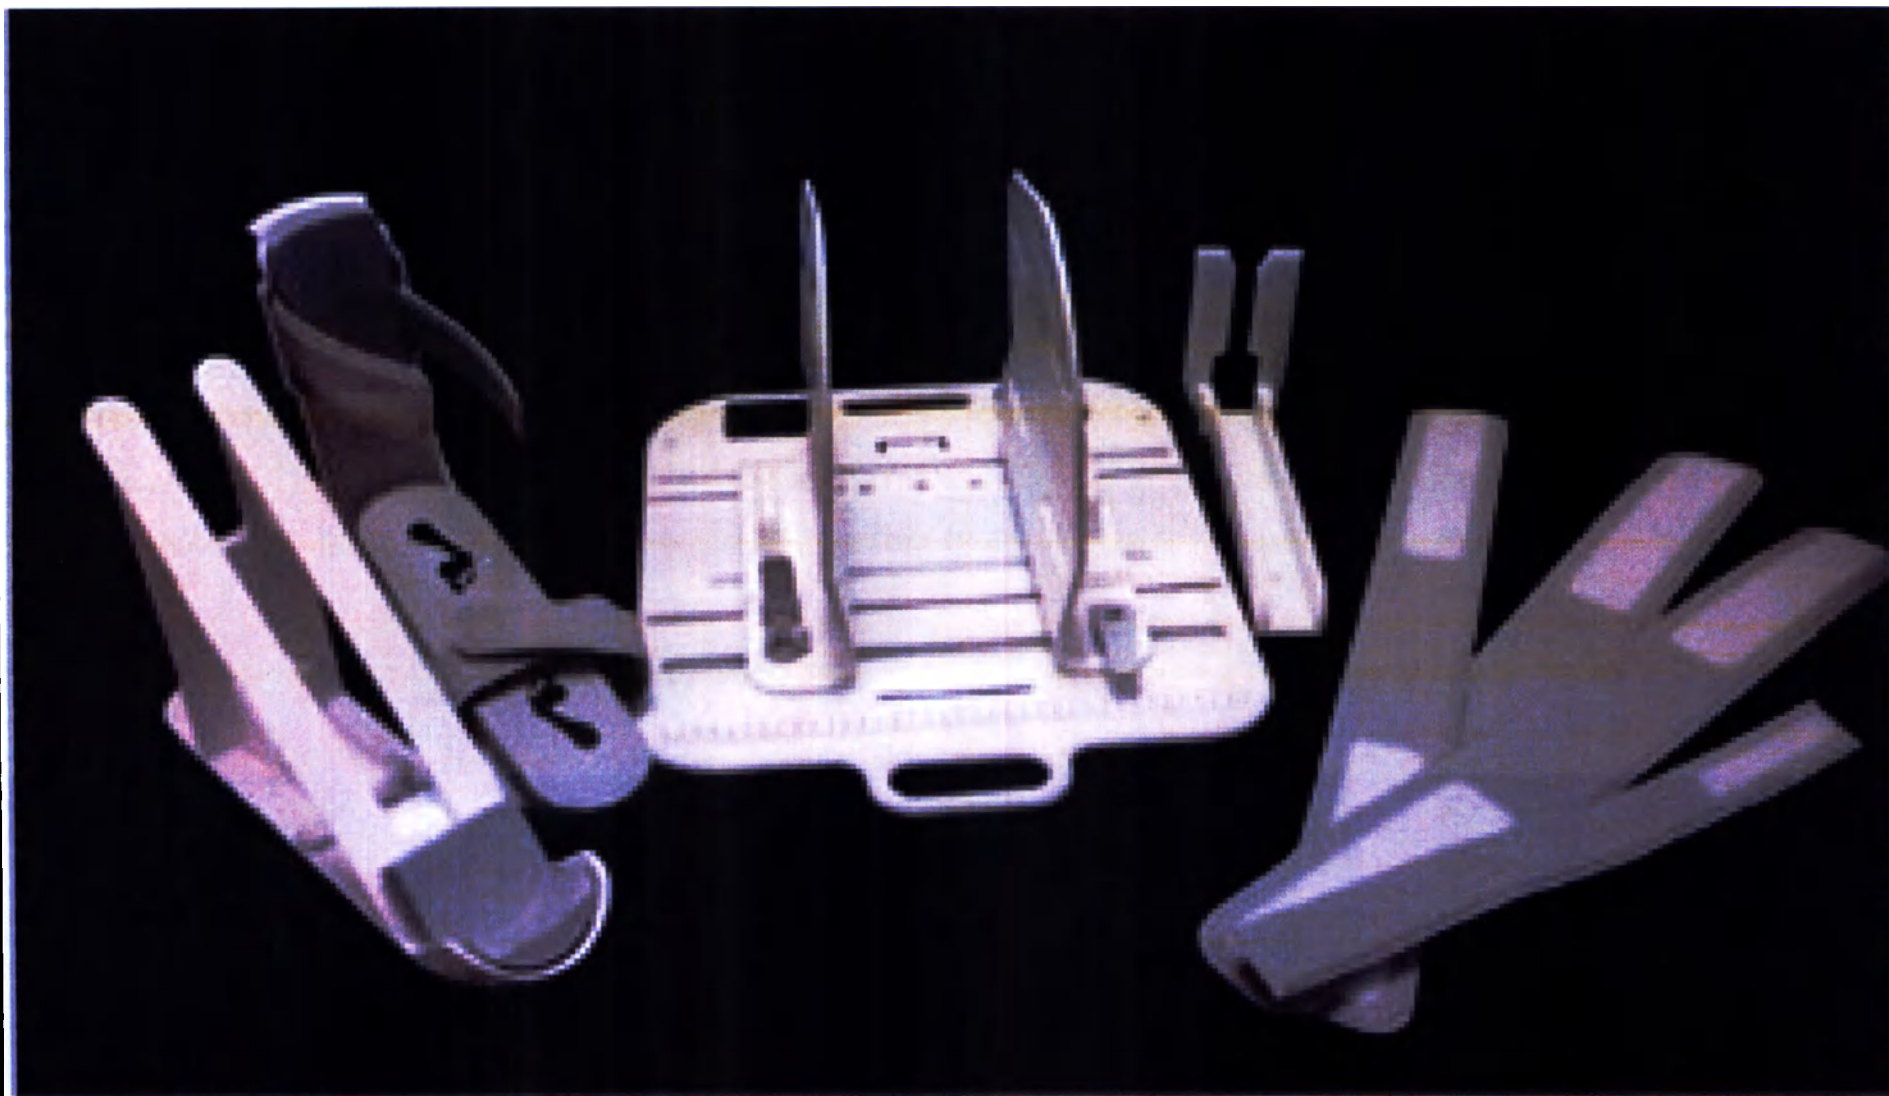


12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).




12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).

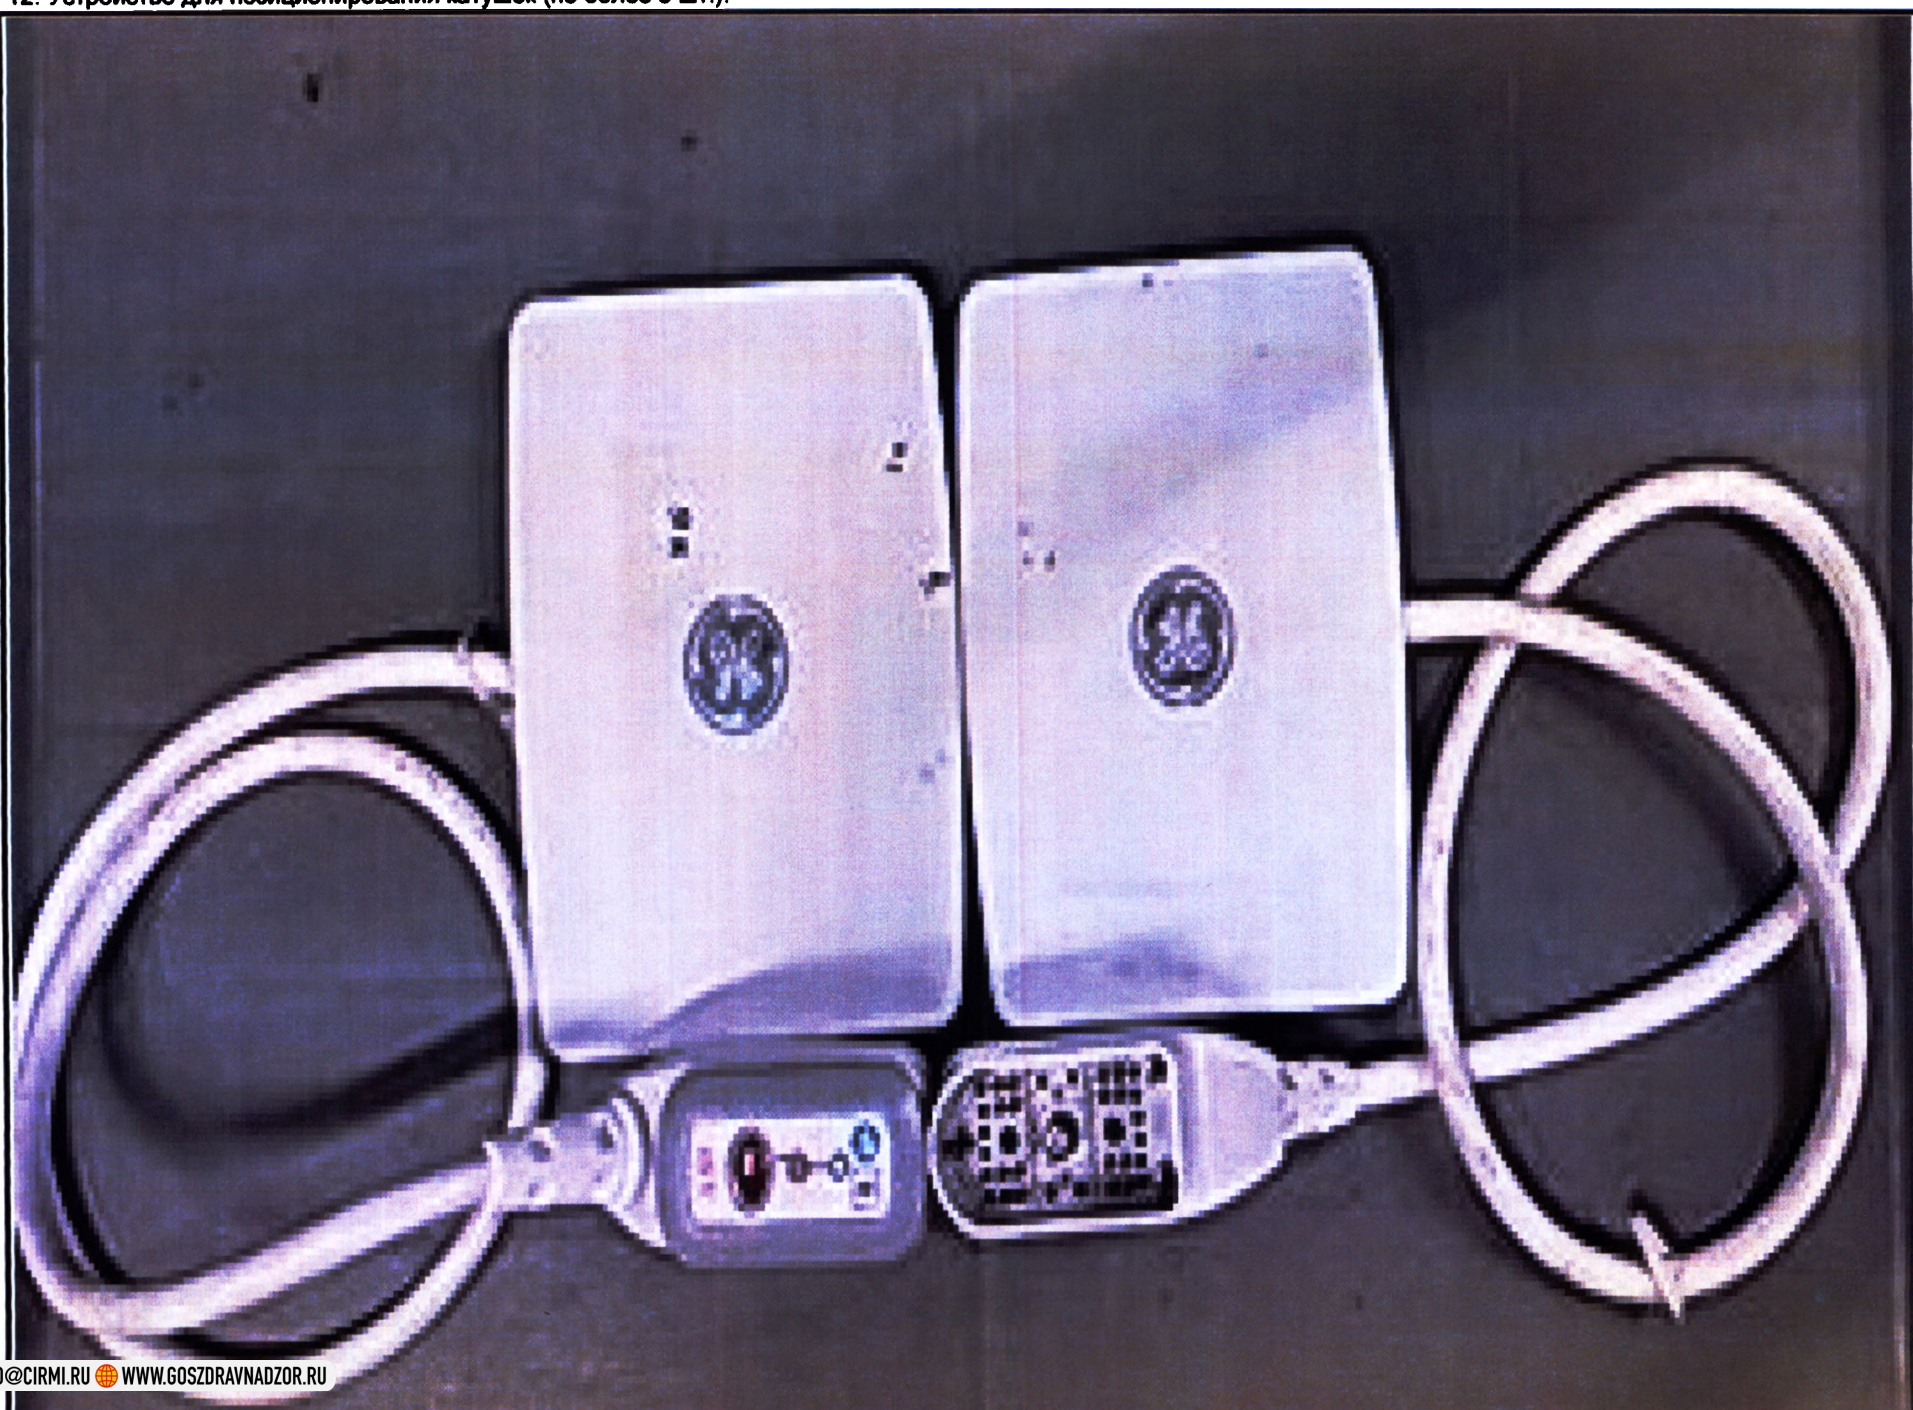

12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).

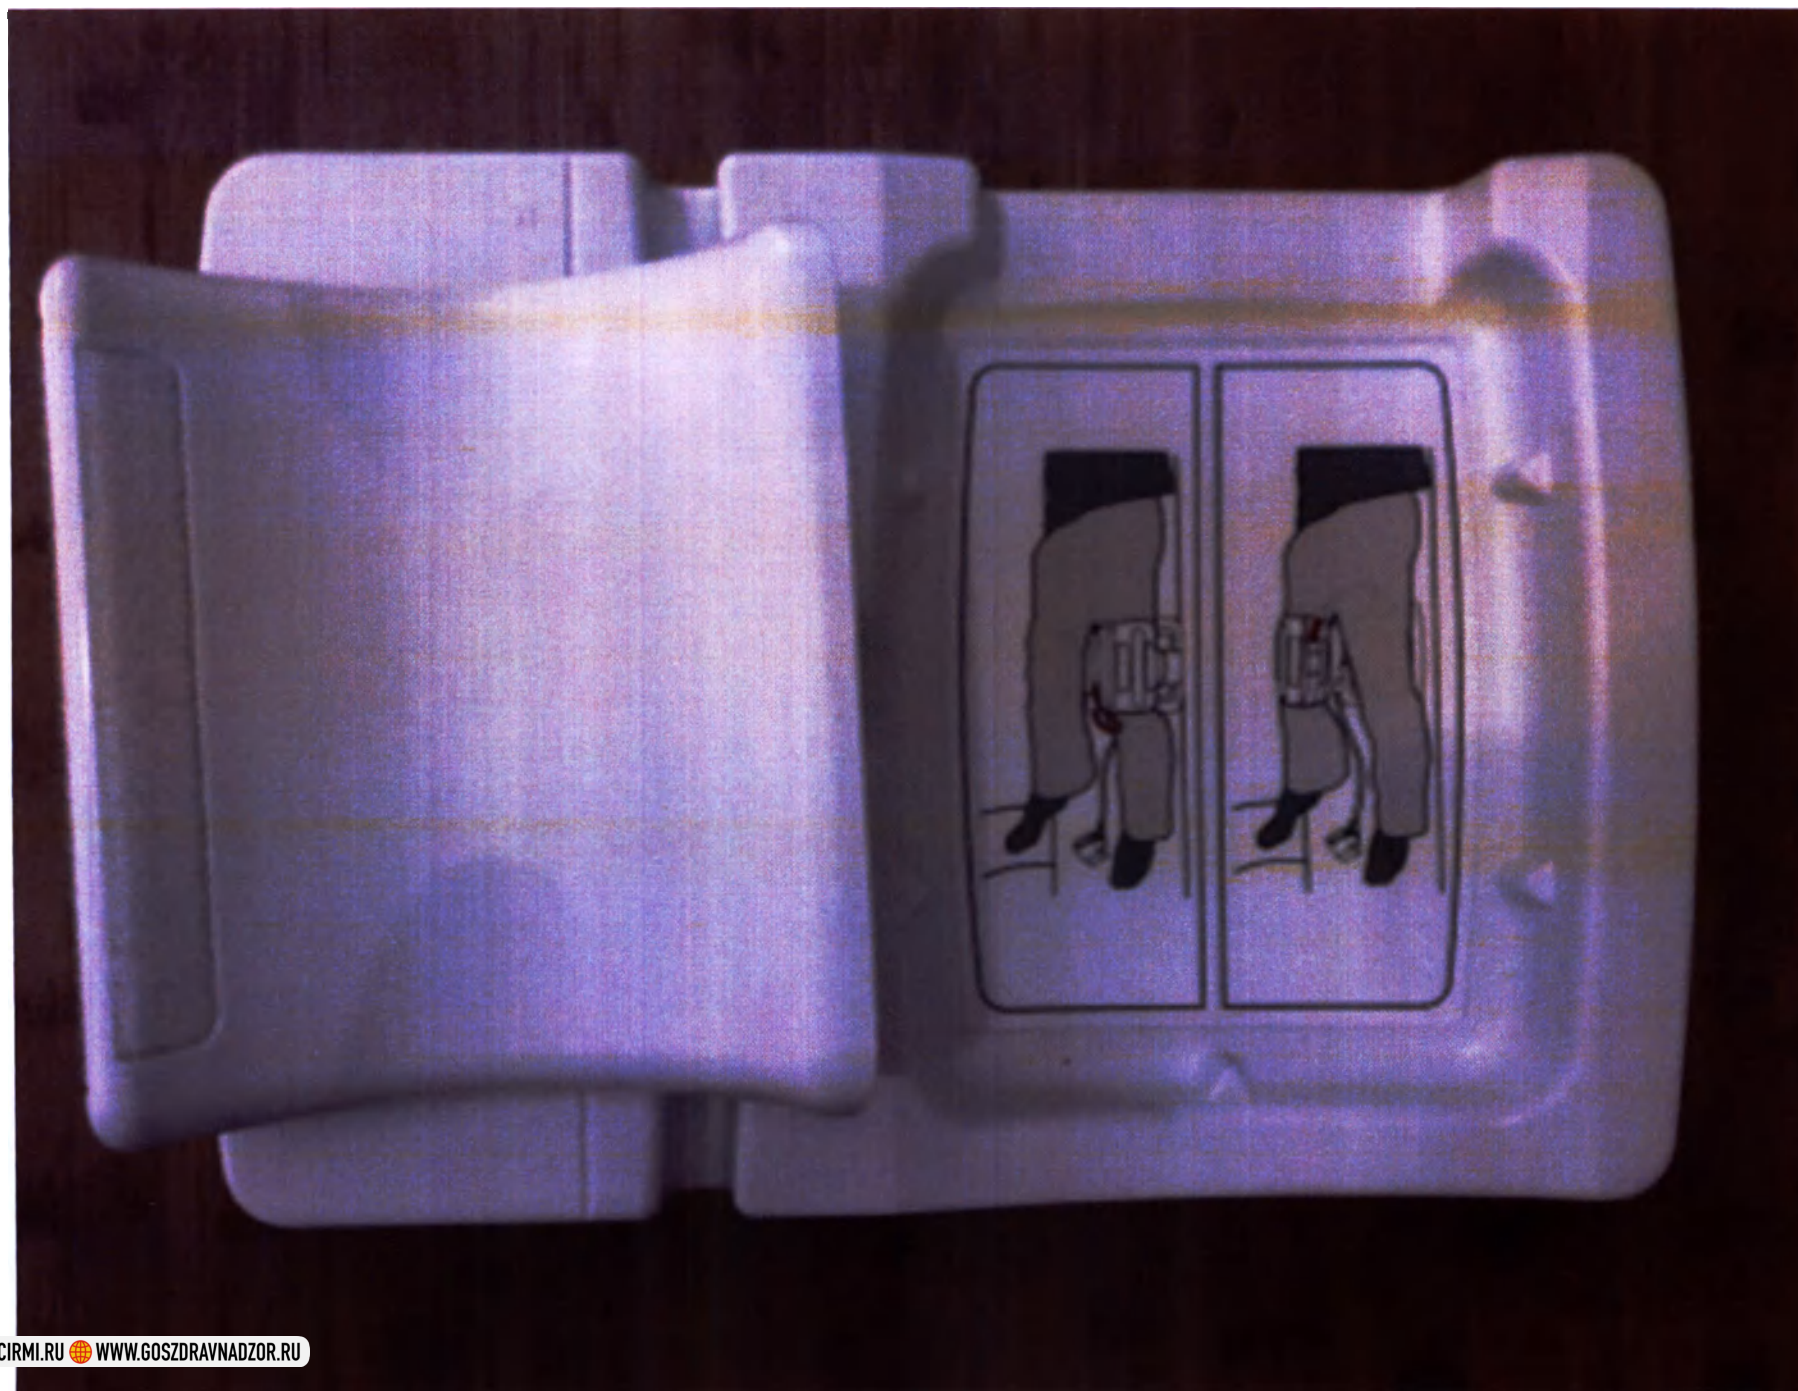

12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).

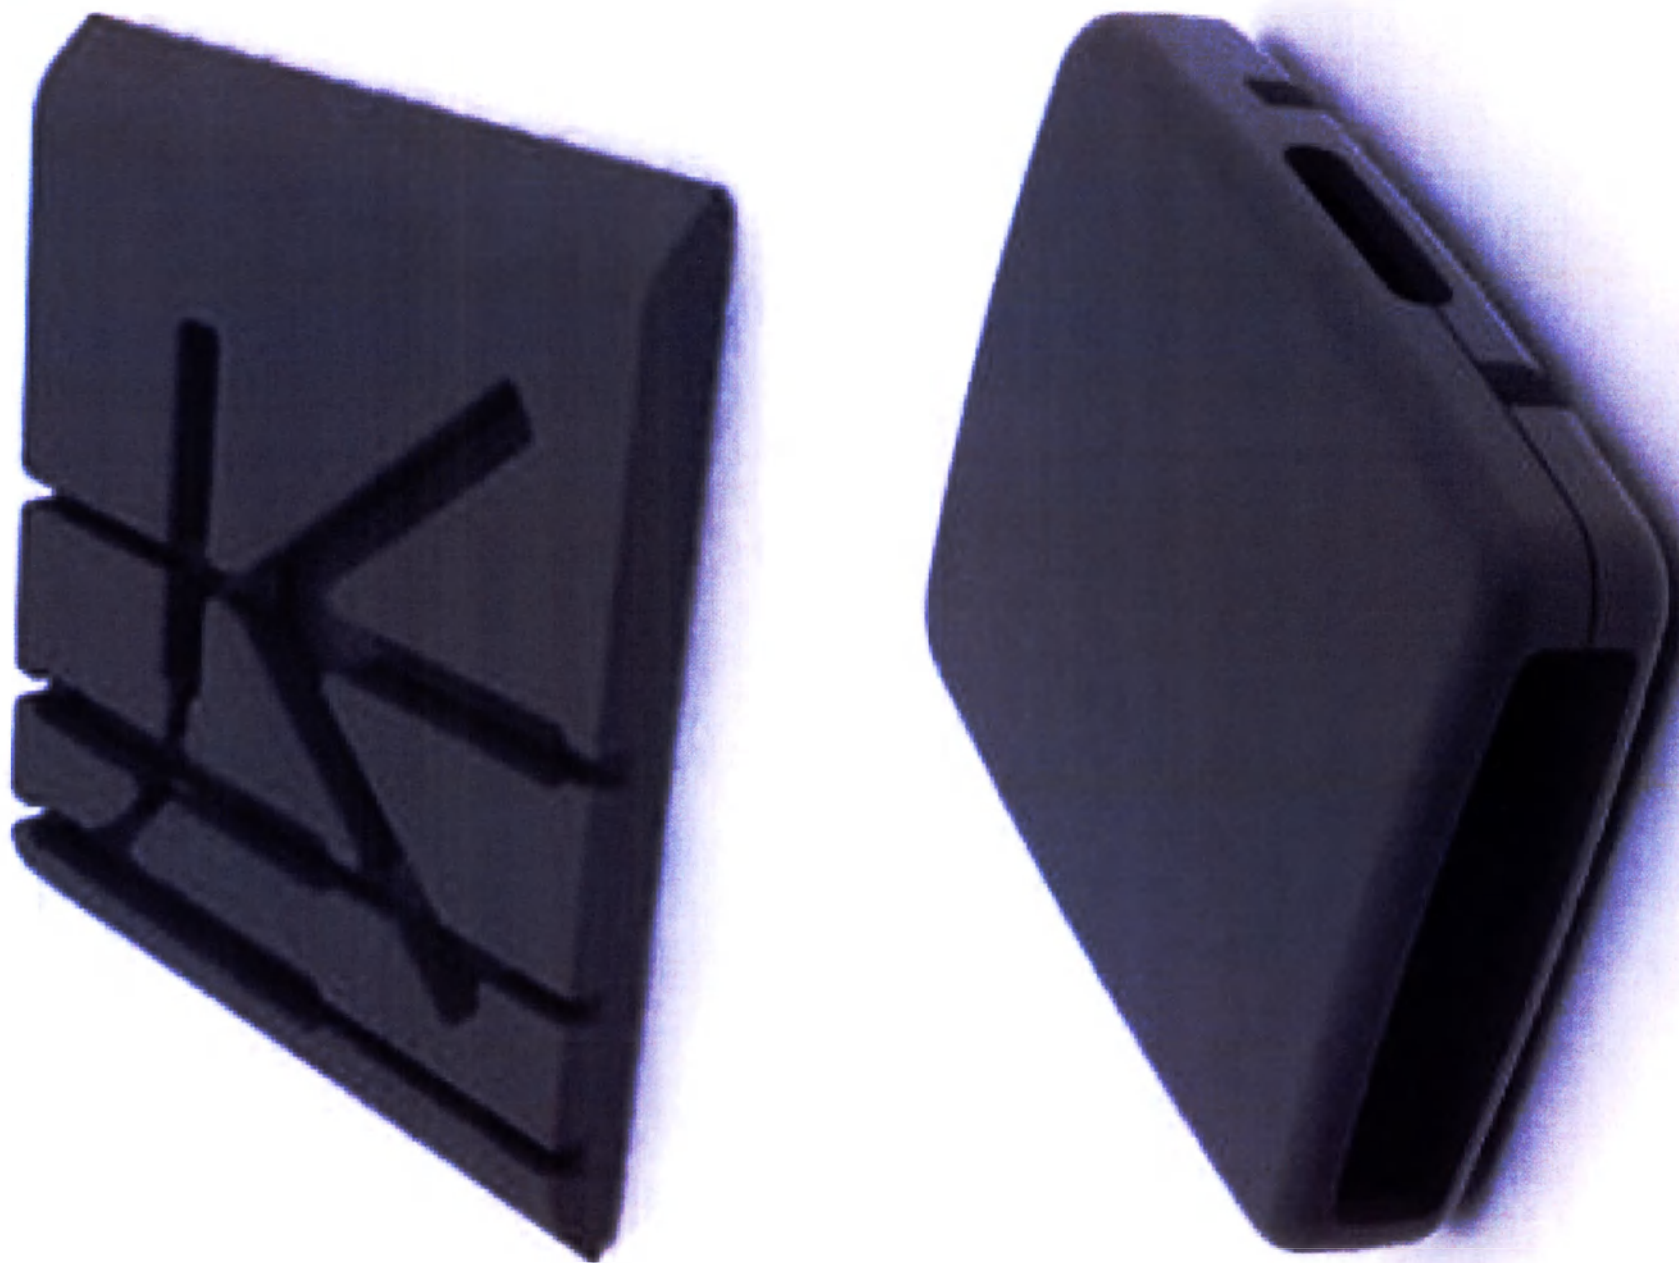

12. Устройство для позиционирования катушек (не более 5 шт.).




13. Специальные непроводящие подложки (не более 10 шт.).











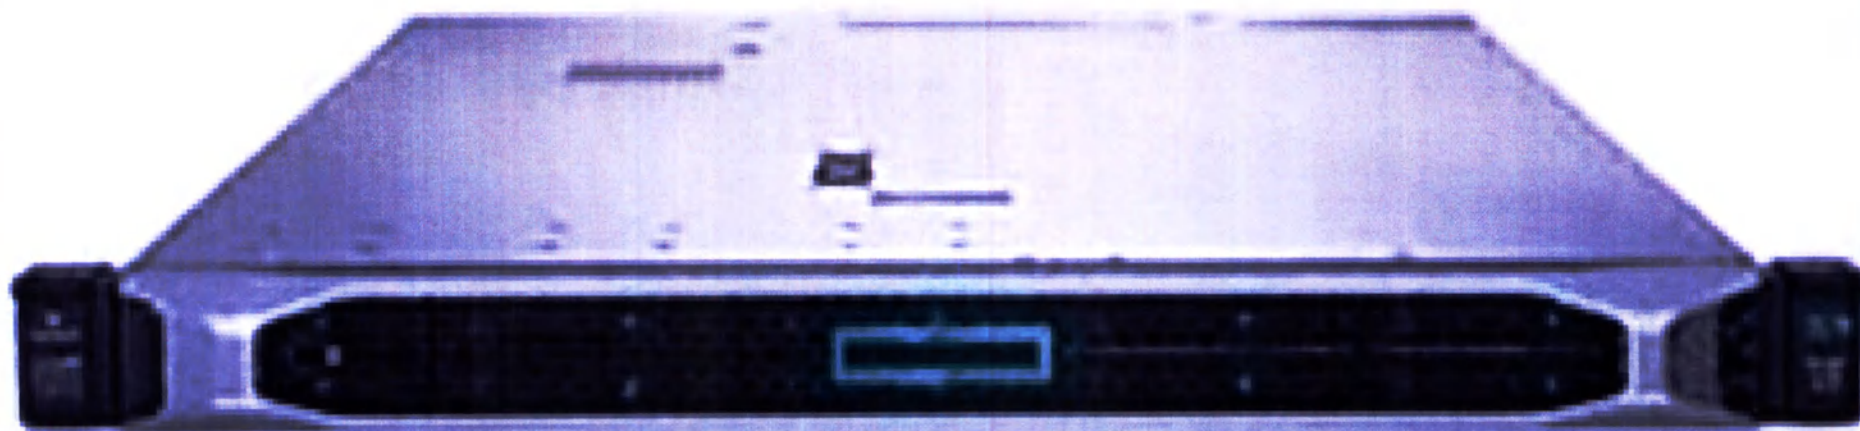




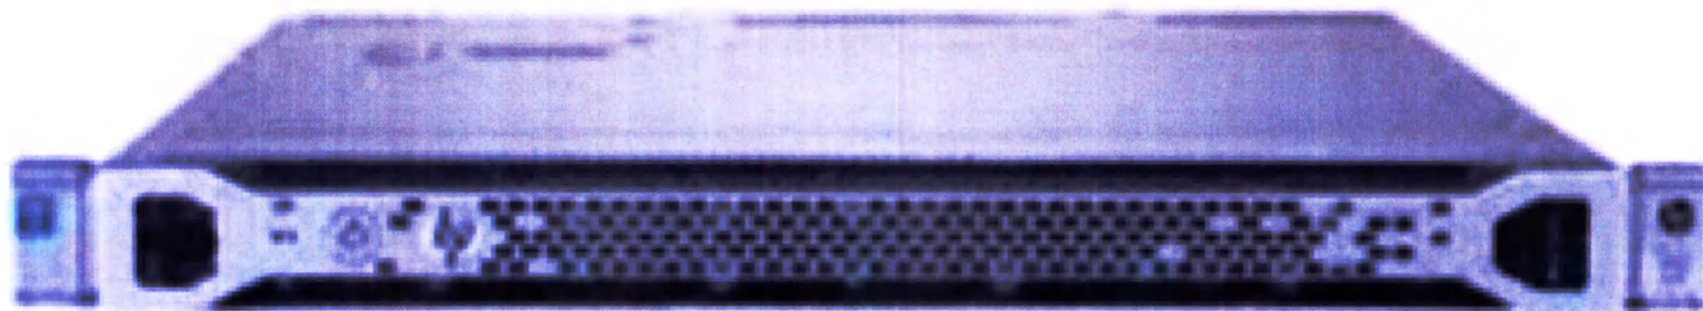

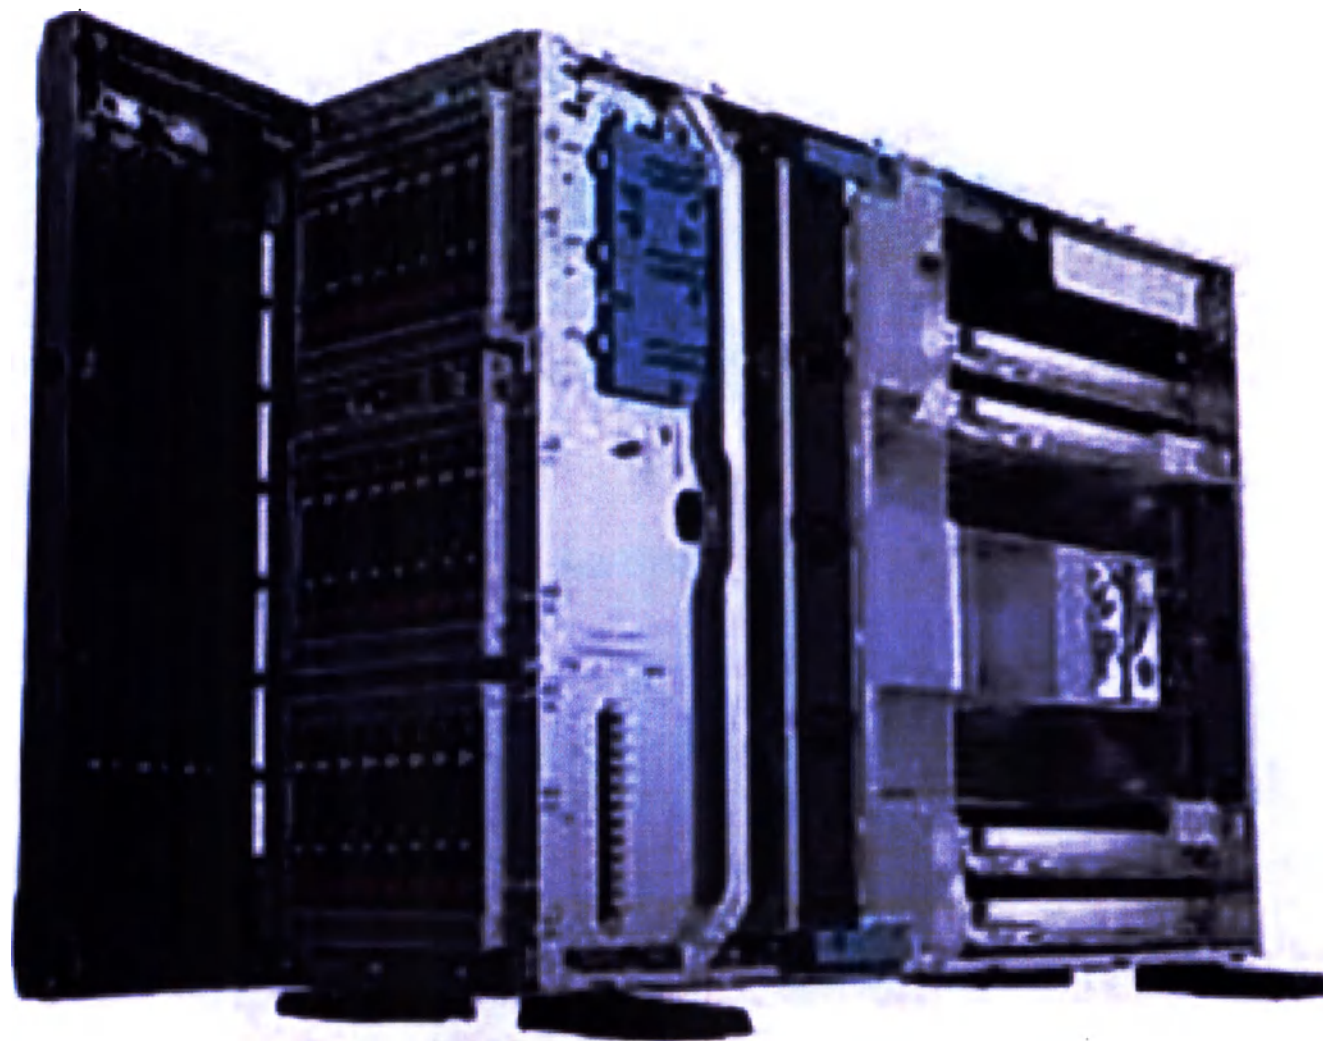



15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).

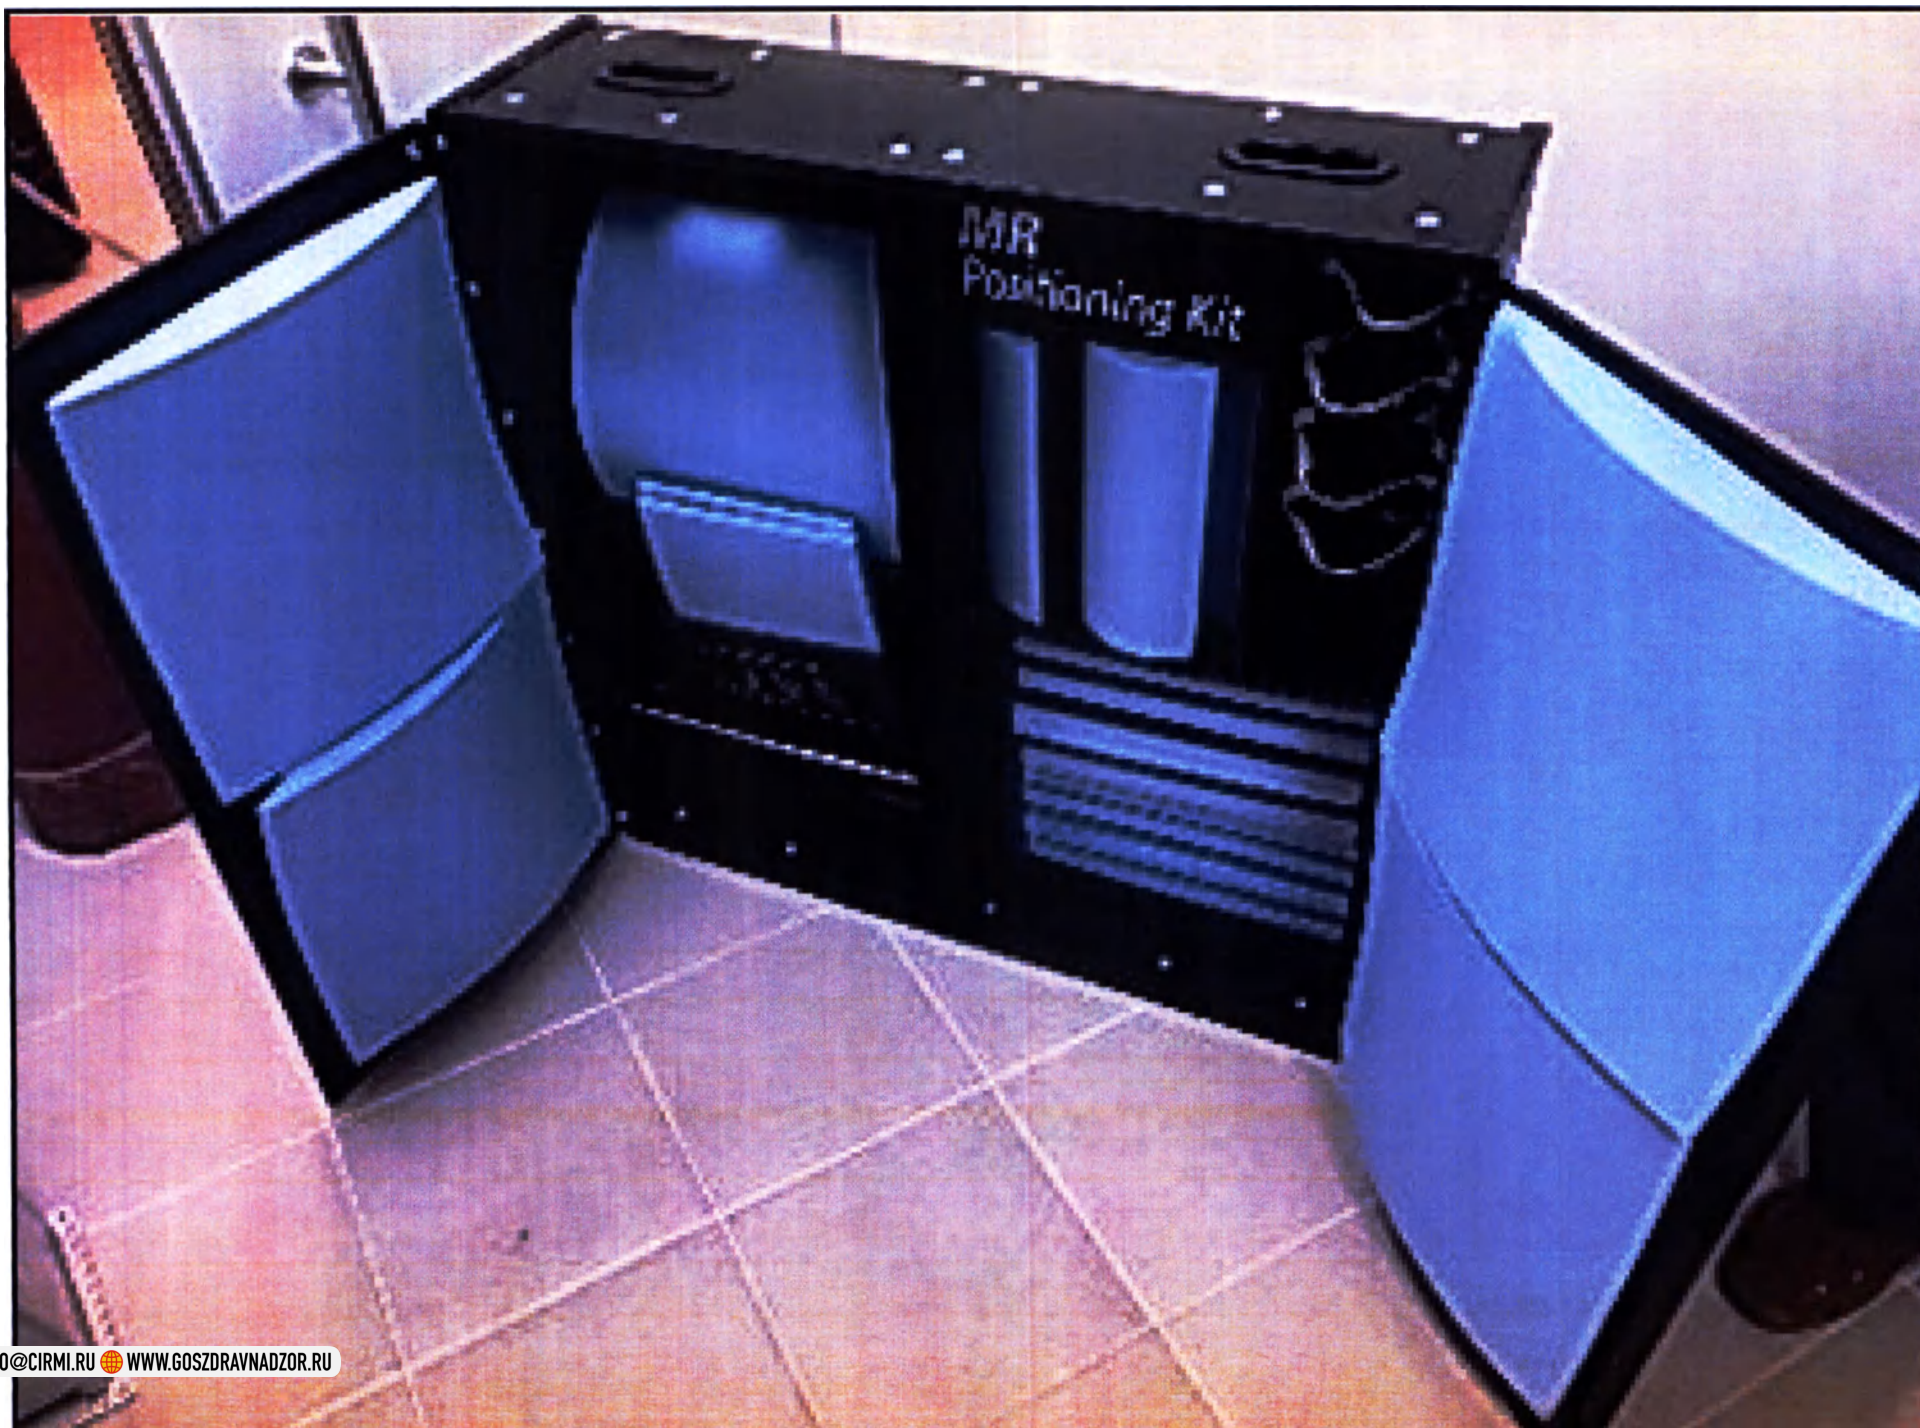


15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).



15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).



15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).

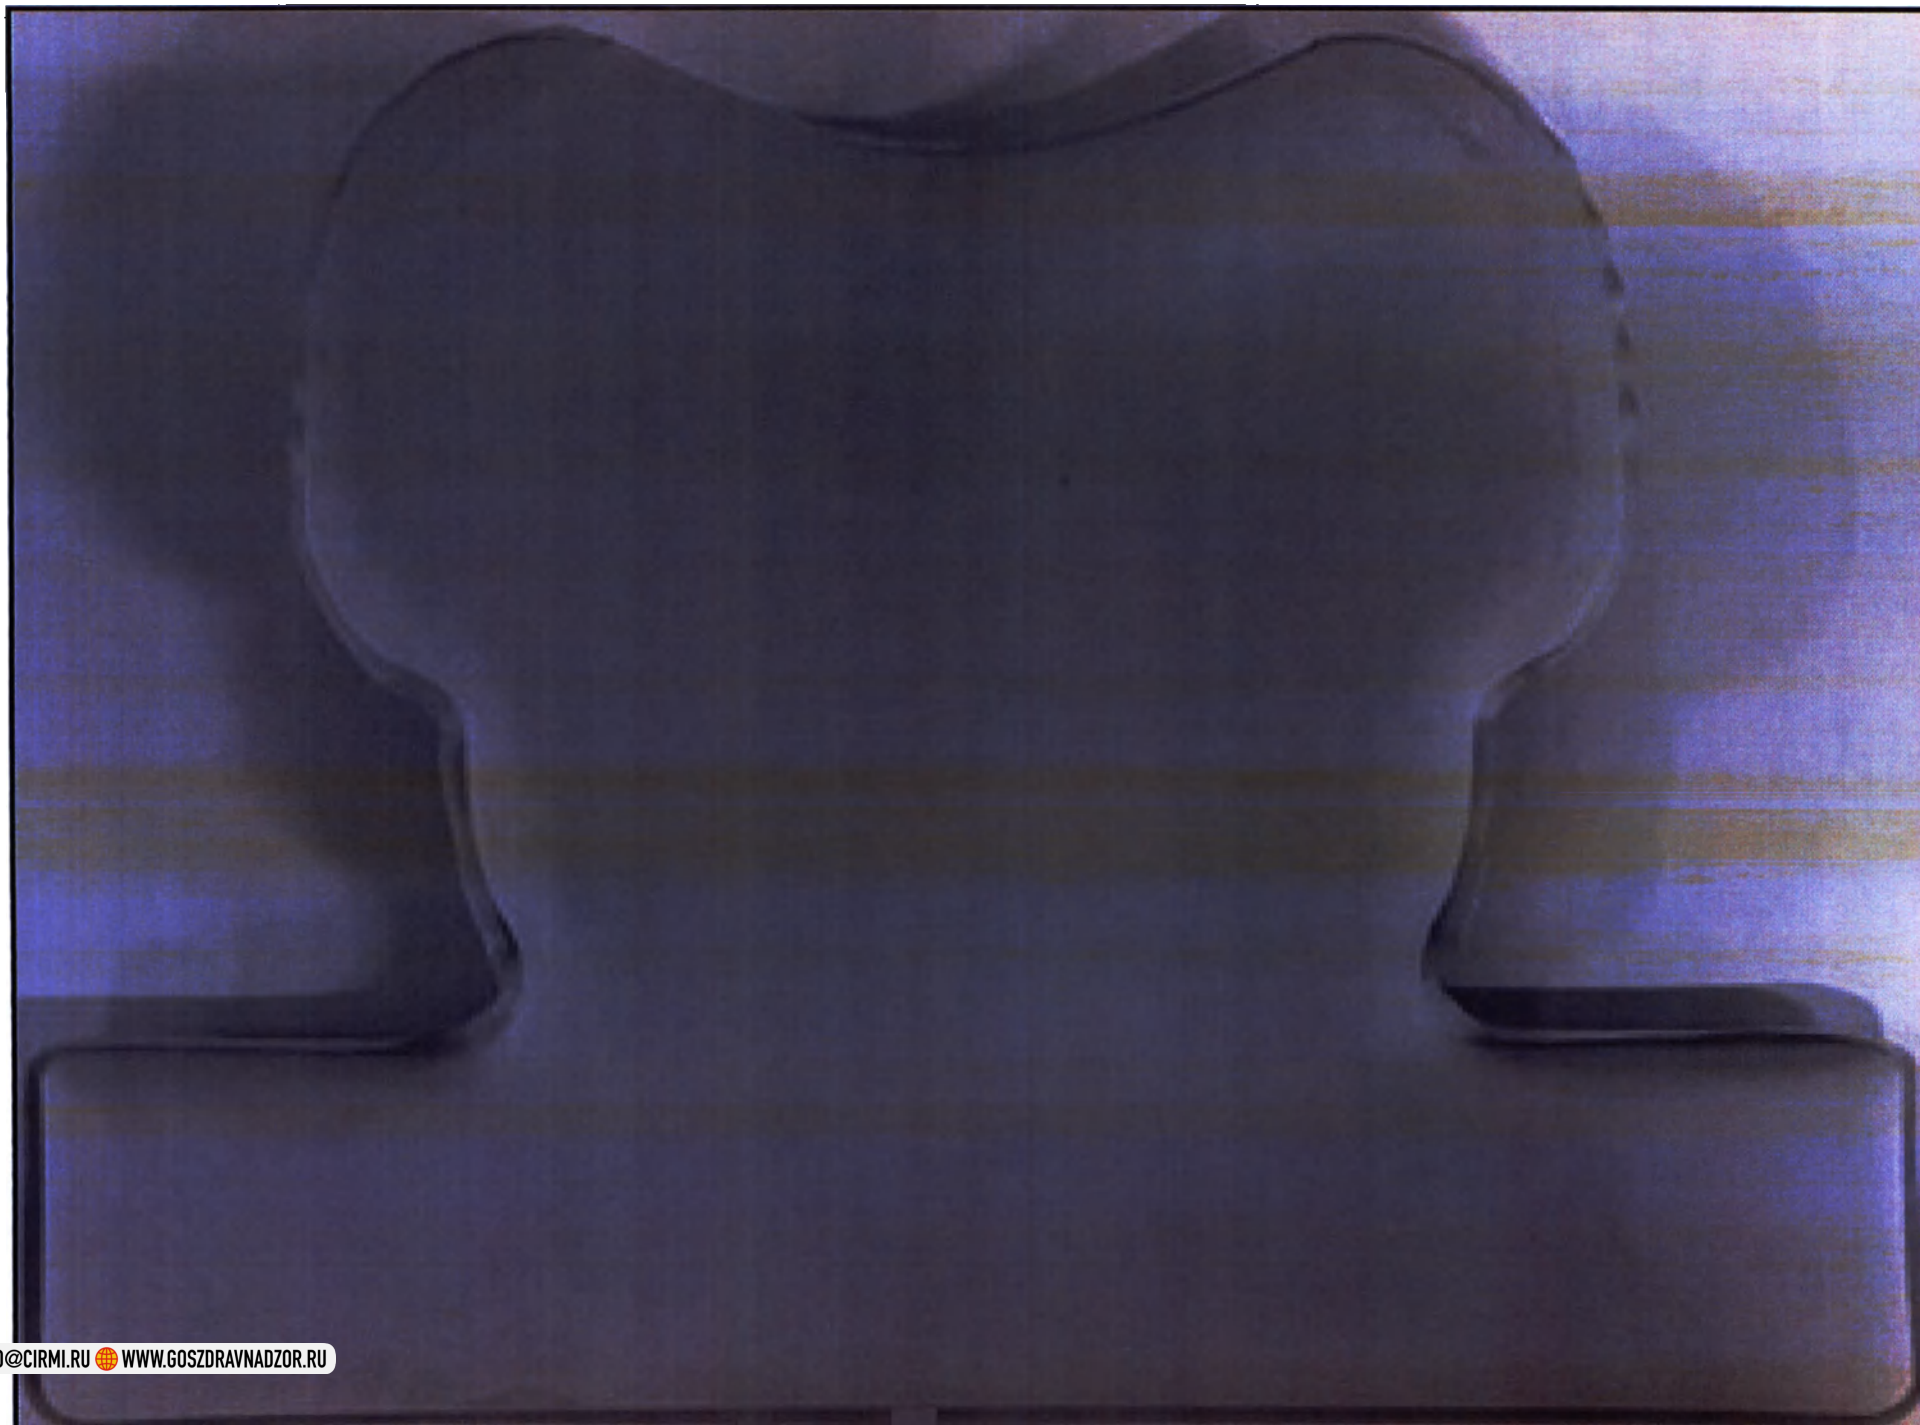


15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).




15. Валики для позиционирования (не более 20 шт.).




16. Программное обеспечение к системе МР томографа на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более 150 шт.).

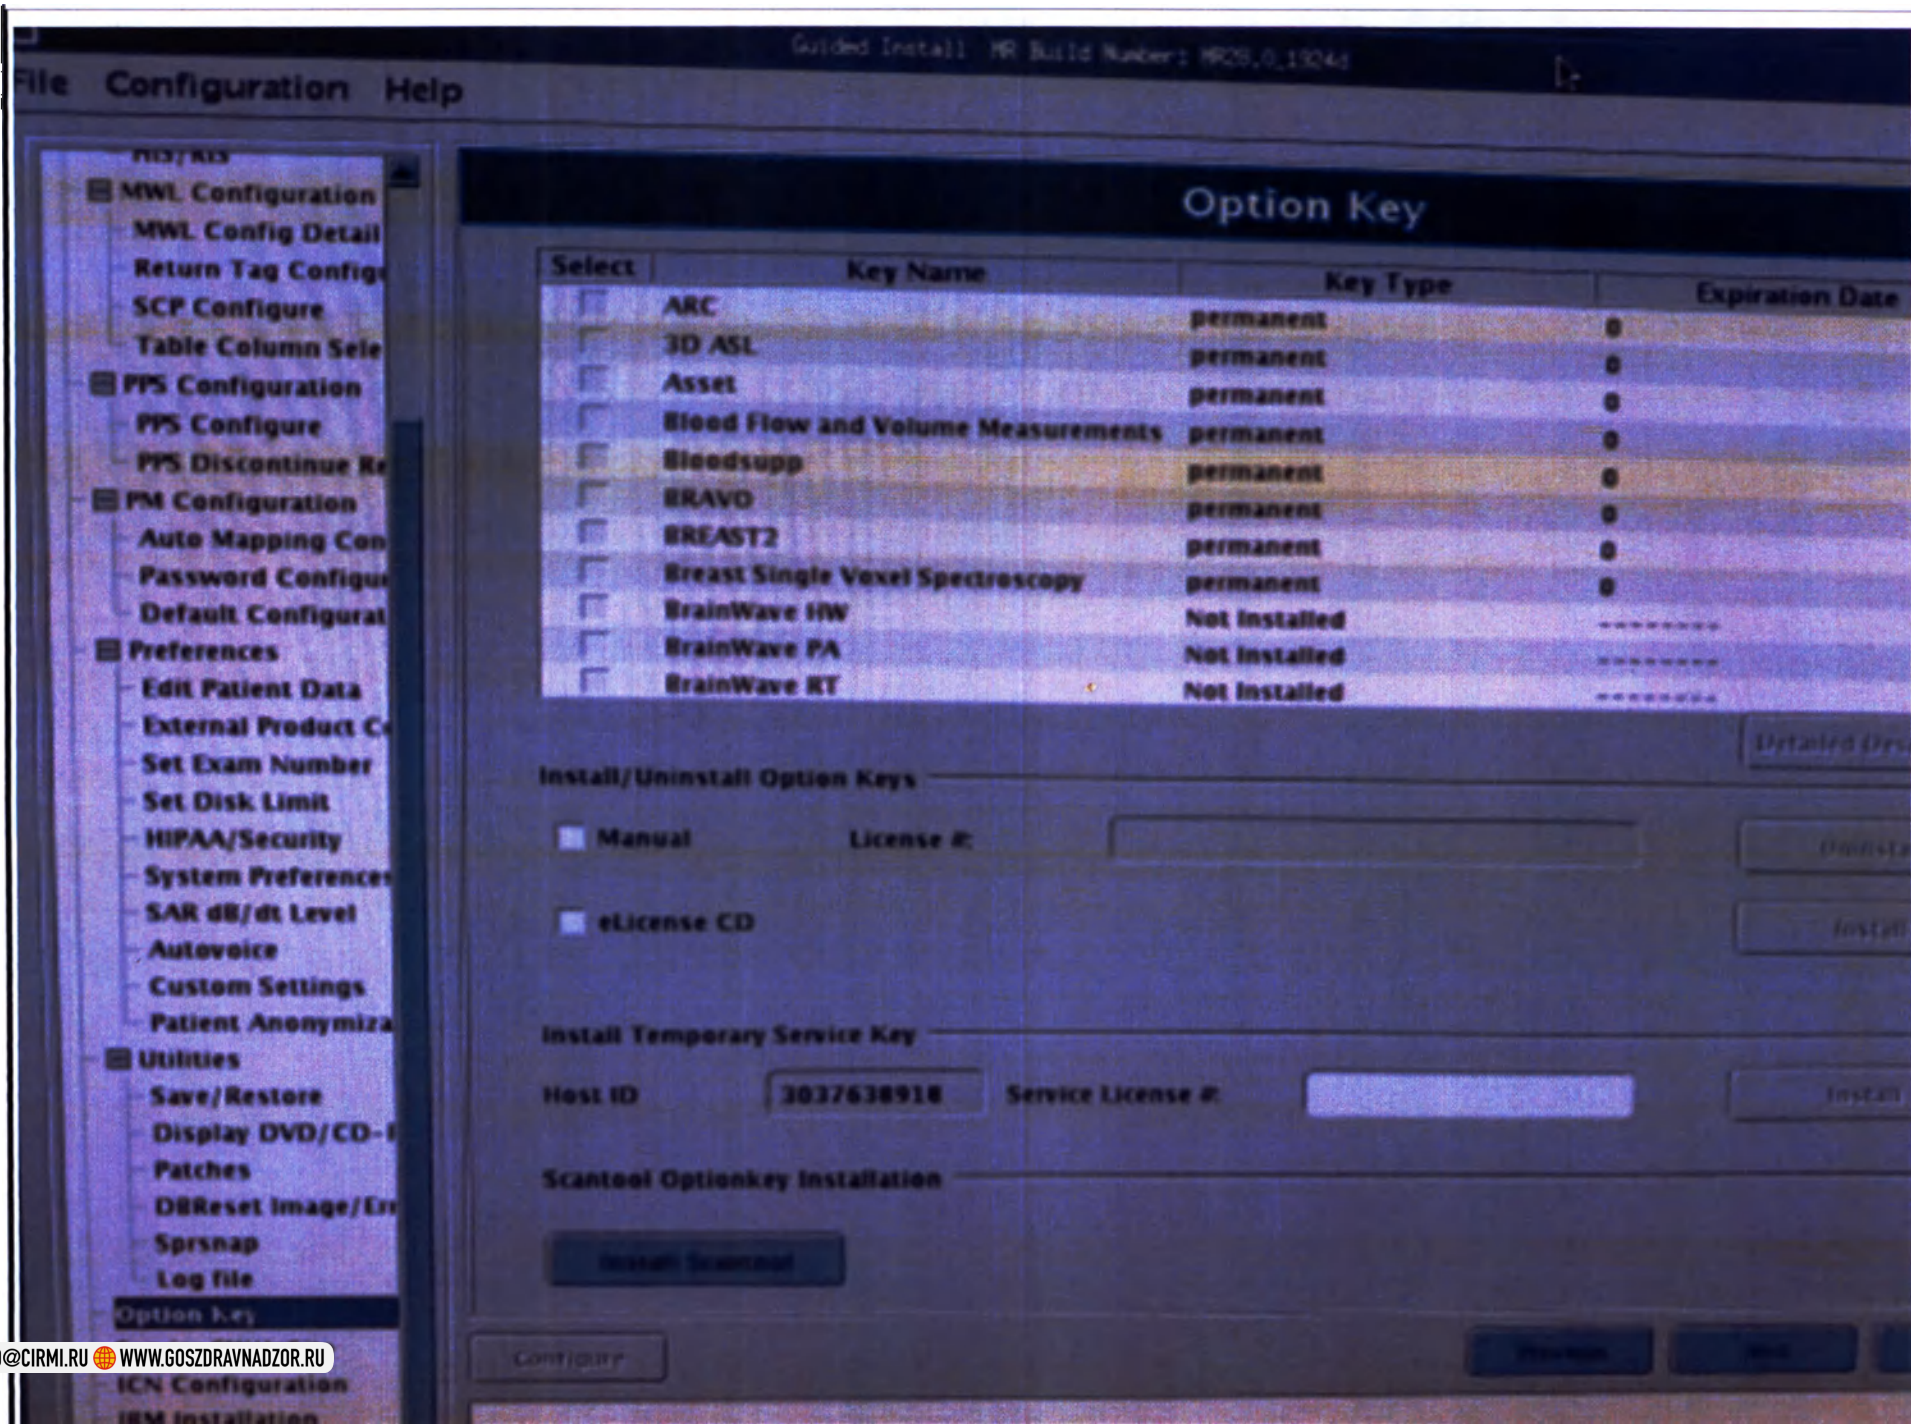

16. Программное обеспечение к системе МР томографа на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более 150 шт.).

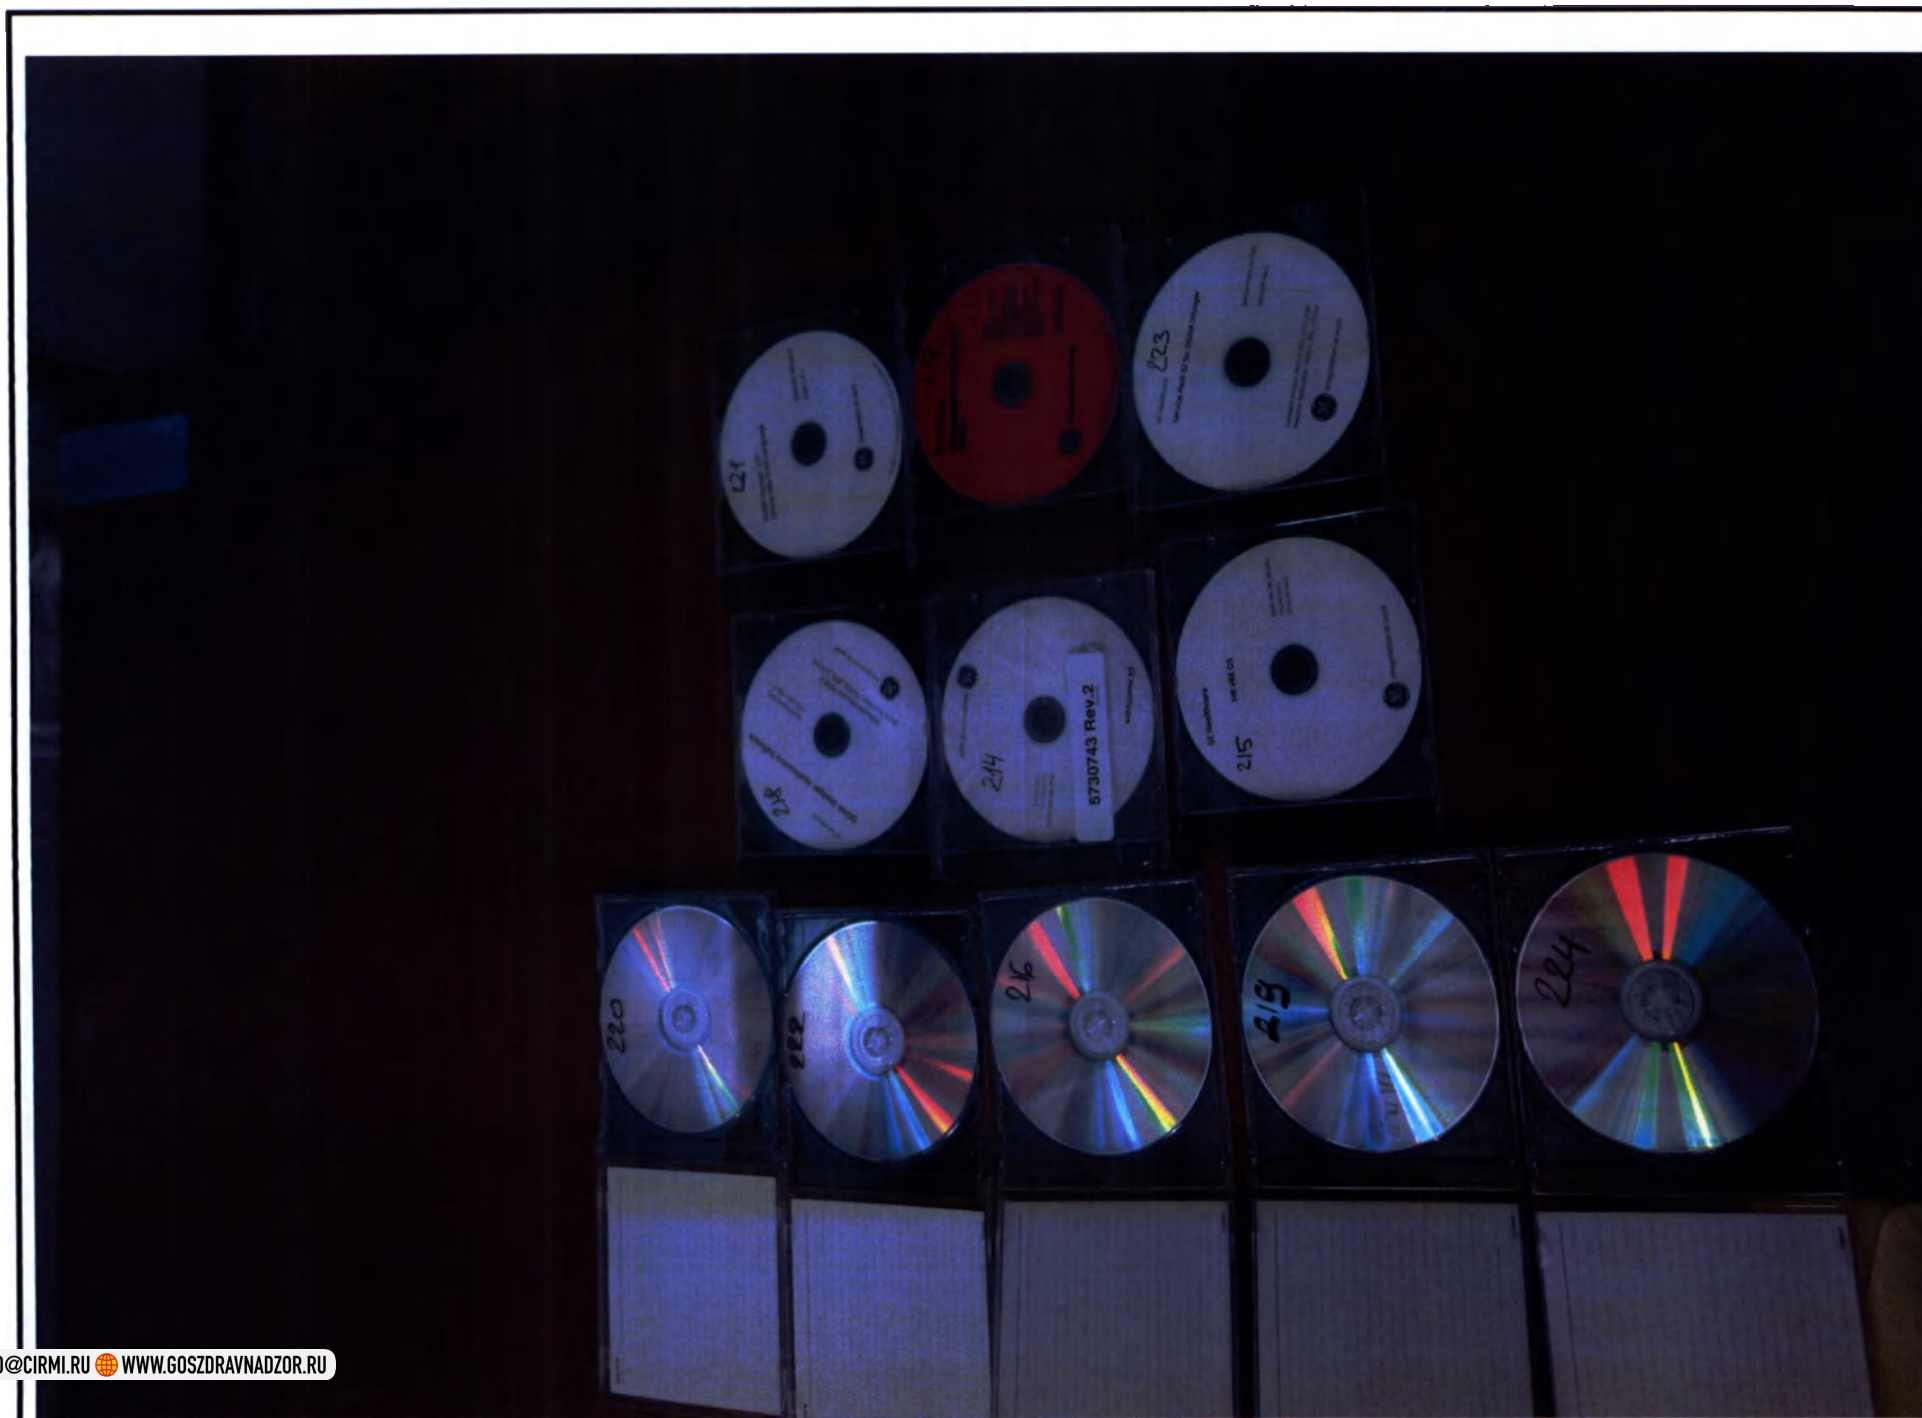

16. Программное обеспечение к системе МР томографа на оптических и (или) электронных и (или) бумажных (ключ активации) носителях (не более 150 шт.).

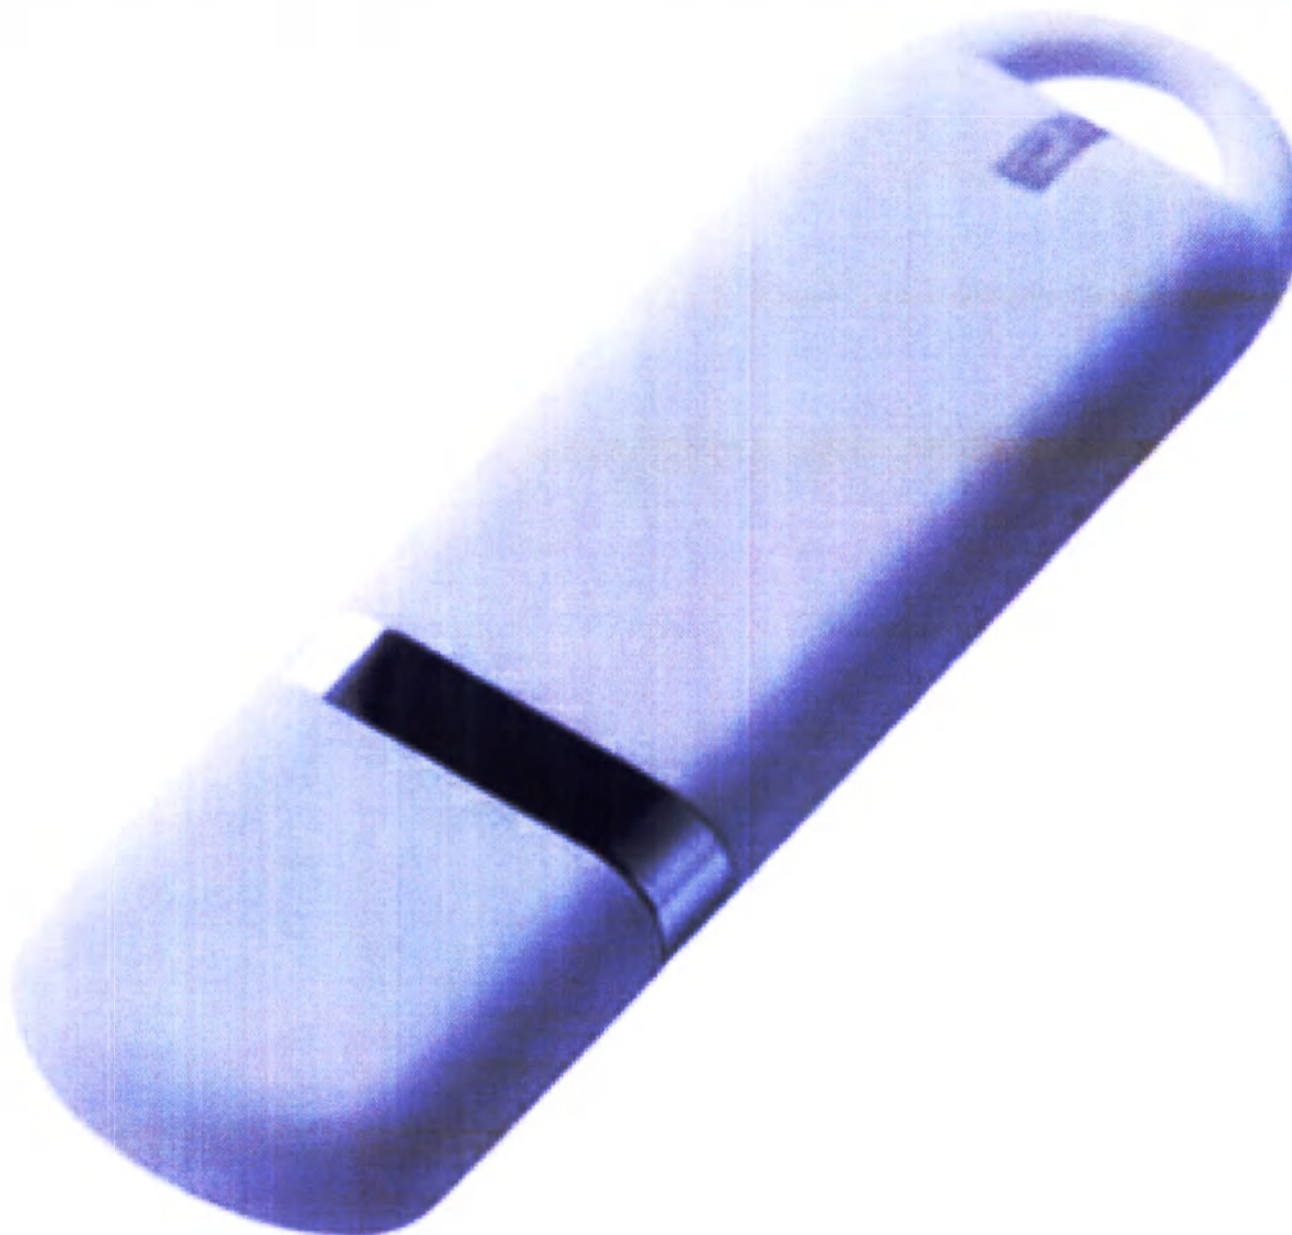

17. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



17. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



17. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



17. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



17. Цветные мониторы медицинские (не более 10 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).



18. Рабочая станция врача для обработки данных (не более 5 шт.).




19. Фантомы (не более 15 шт.).




19. Фантомы (не более 15 шт.).



19. Фантомы (не более 15 шт.).

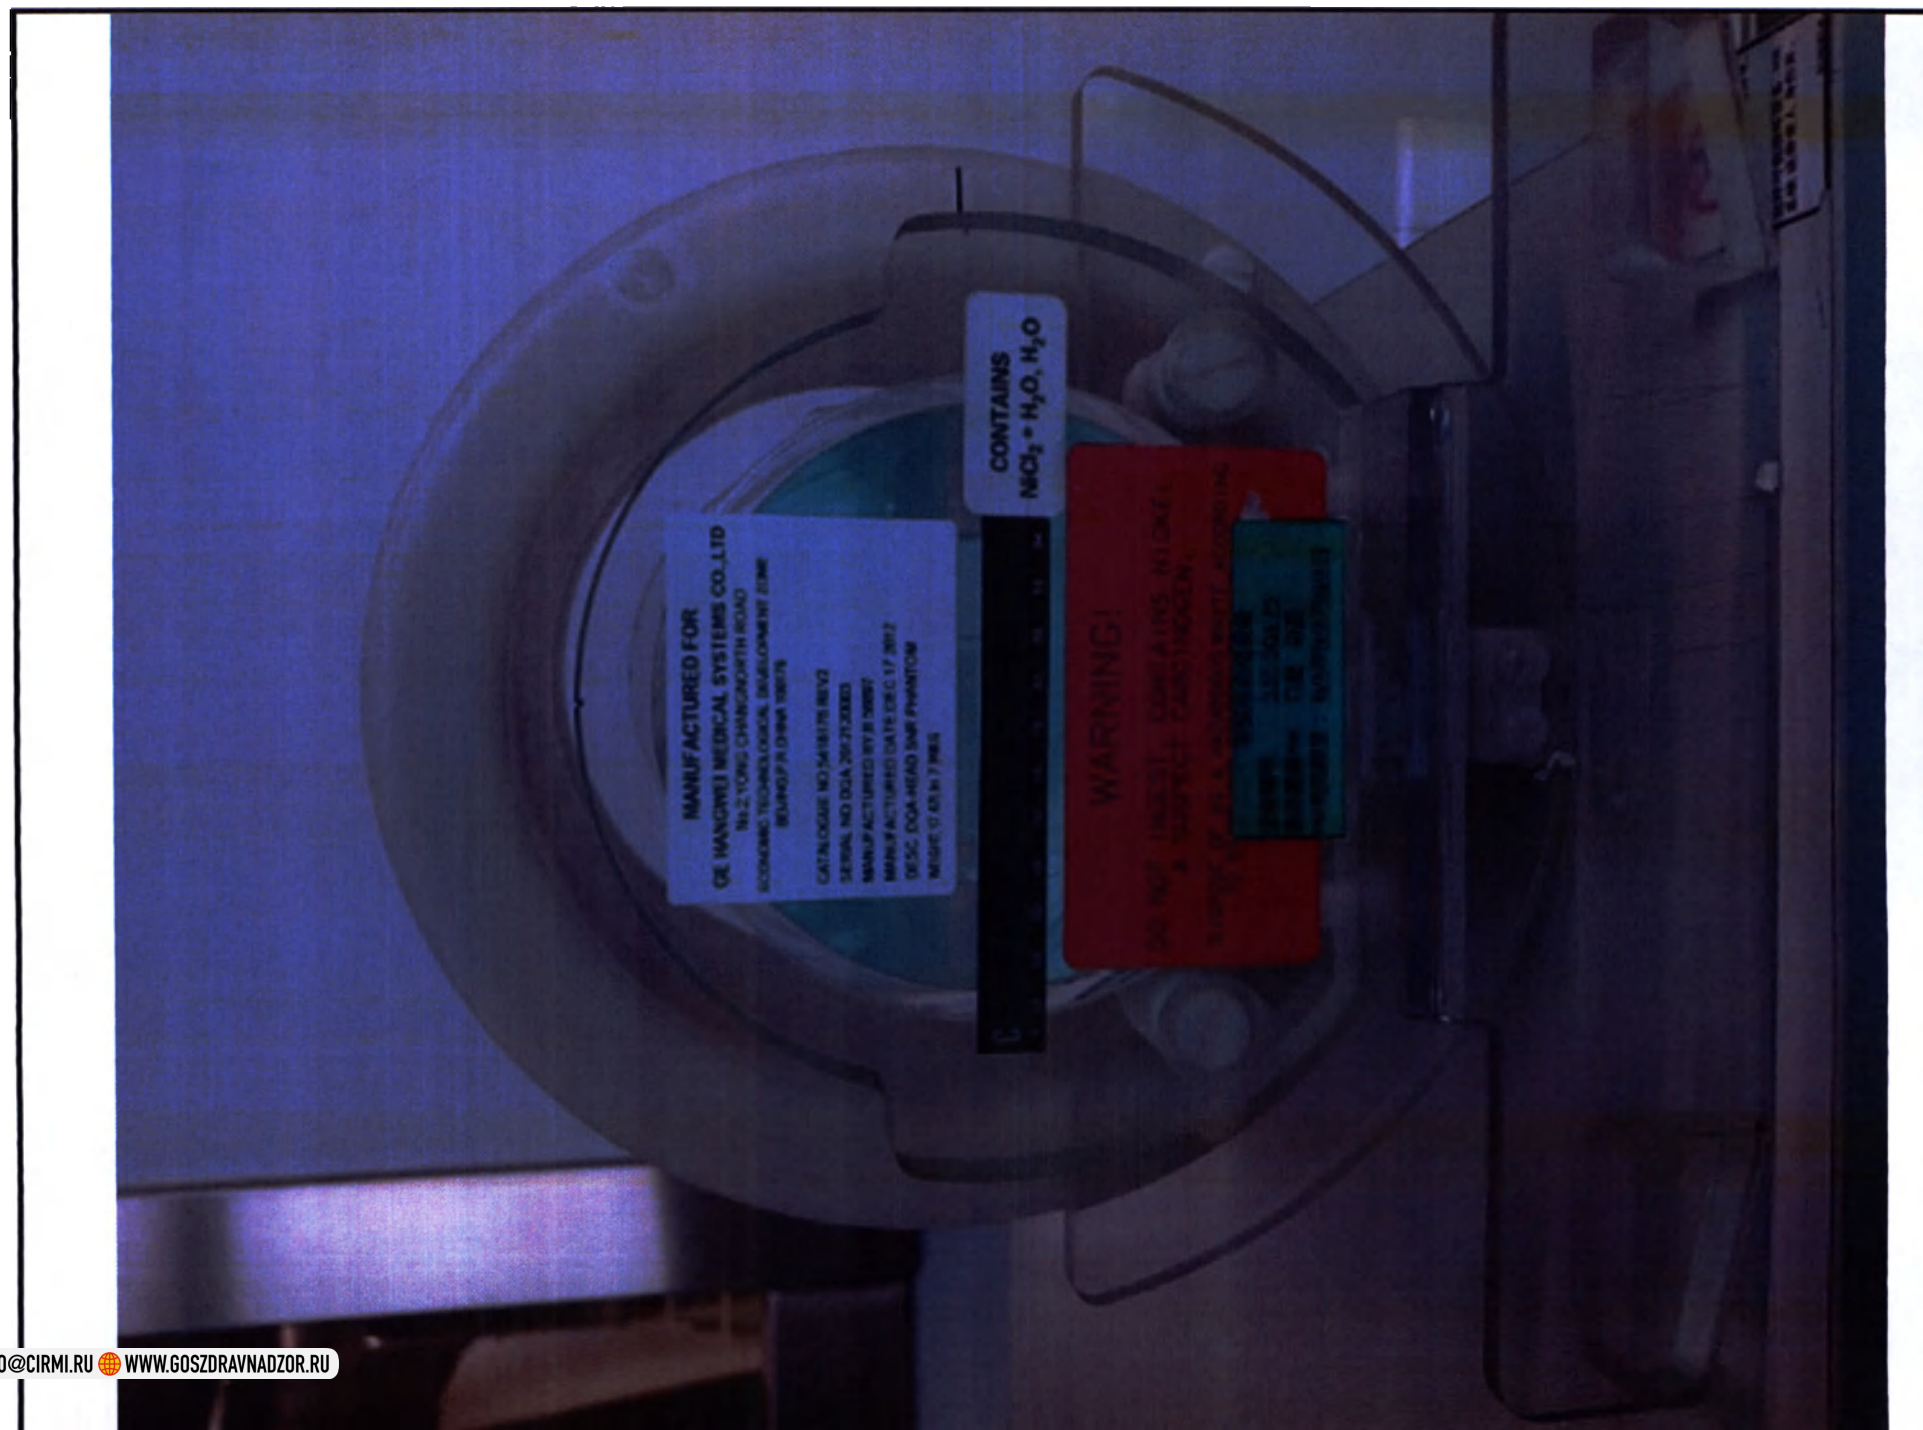

19. Фантомы (не более 15 шт.).

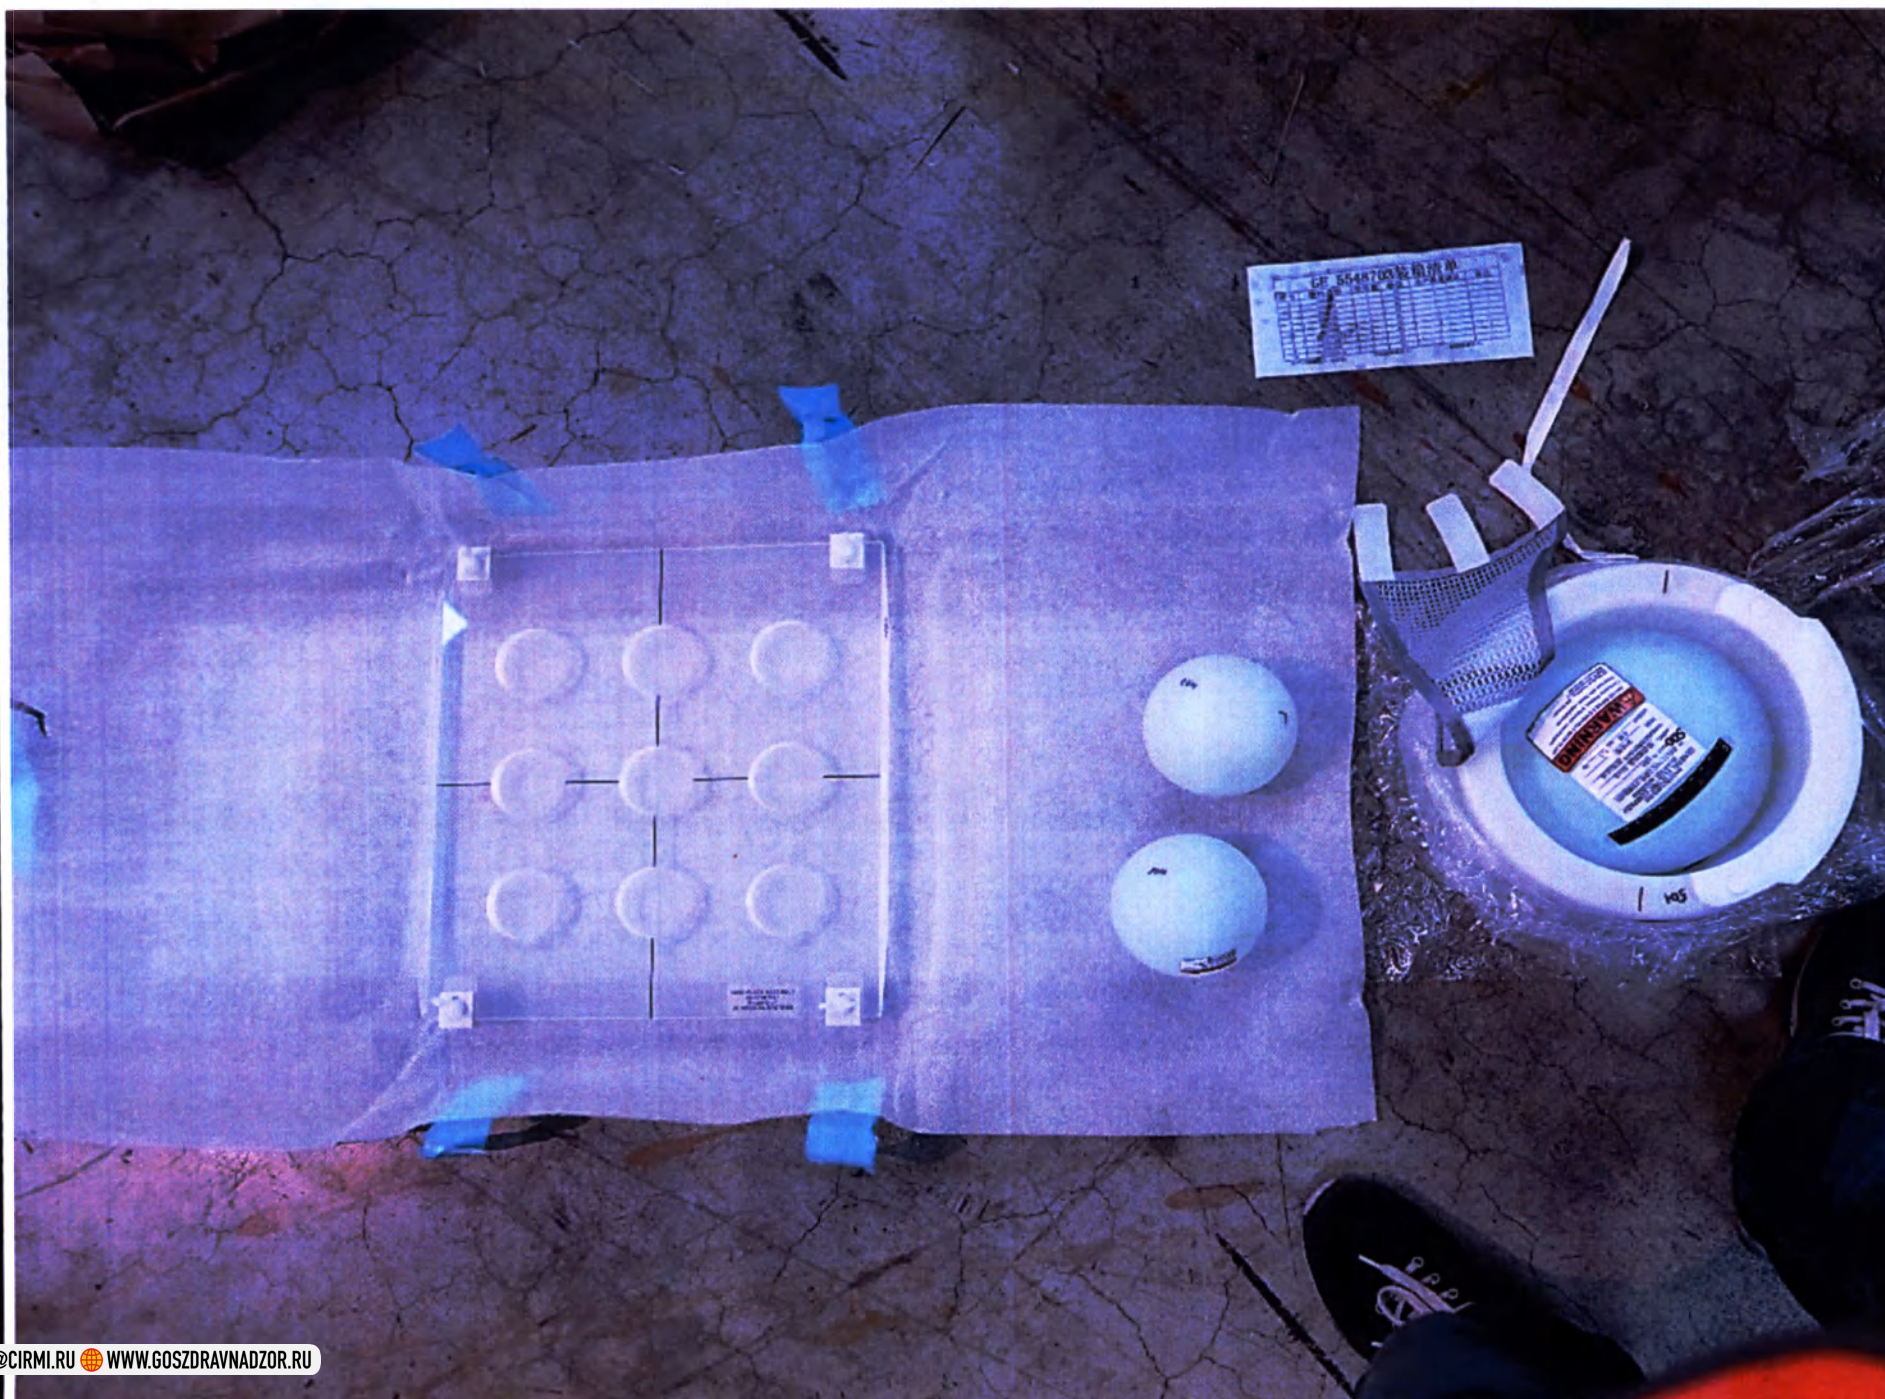

20. Кабели силовые (не более 200 шт.).



20. Кабели силовые (не более 200 шт.).




20. Кабели силовые (не более 200 шт.).



20. Кабели силовые (не более 200 шт.).



20. Кабели силовые (не более 200 шт.).

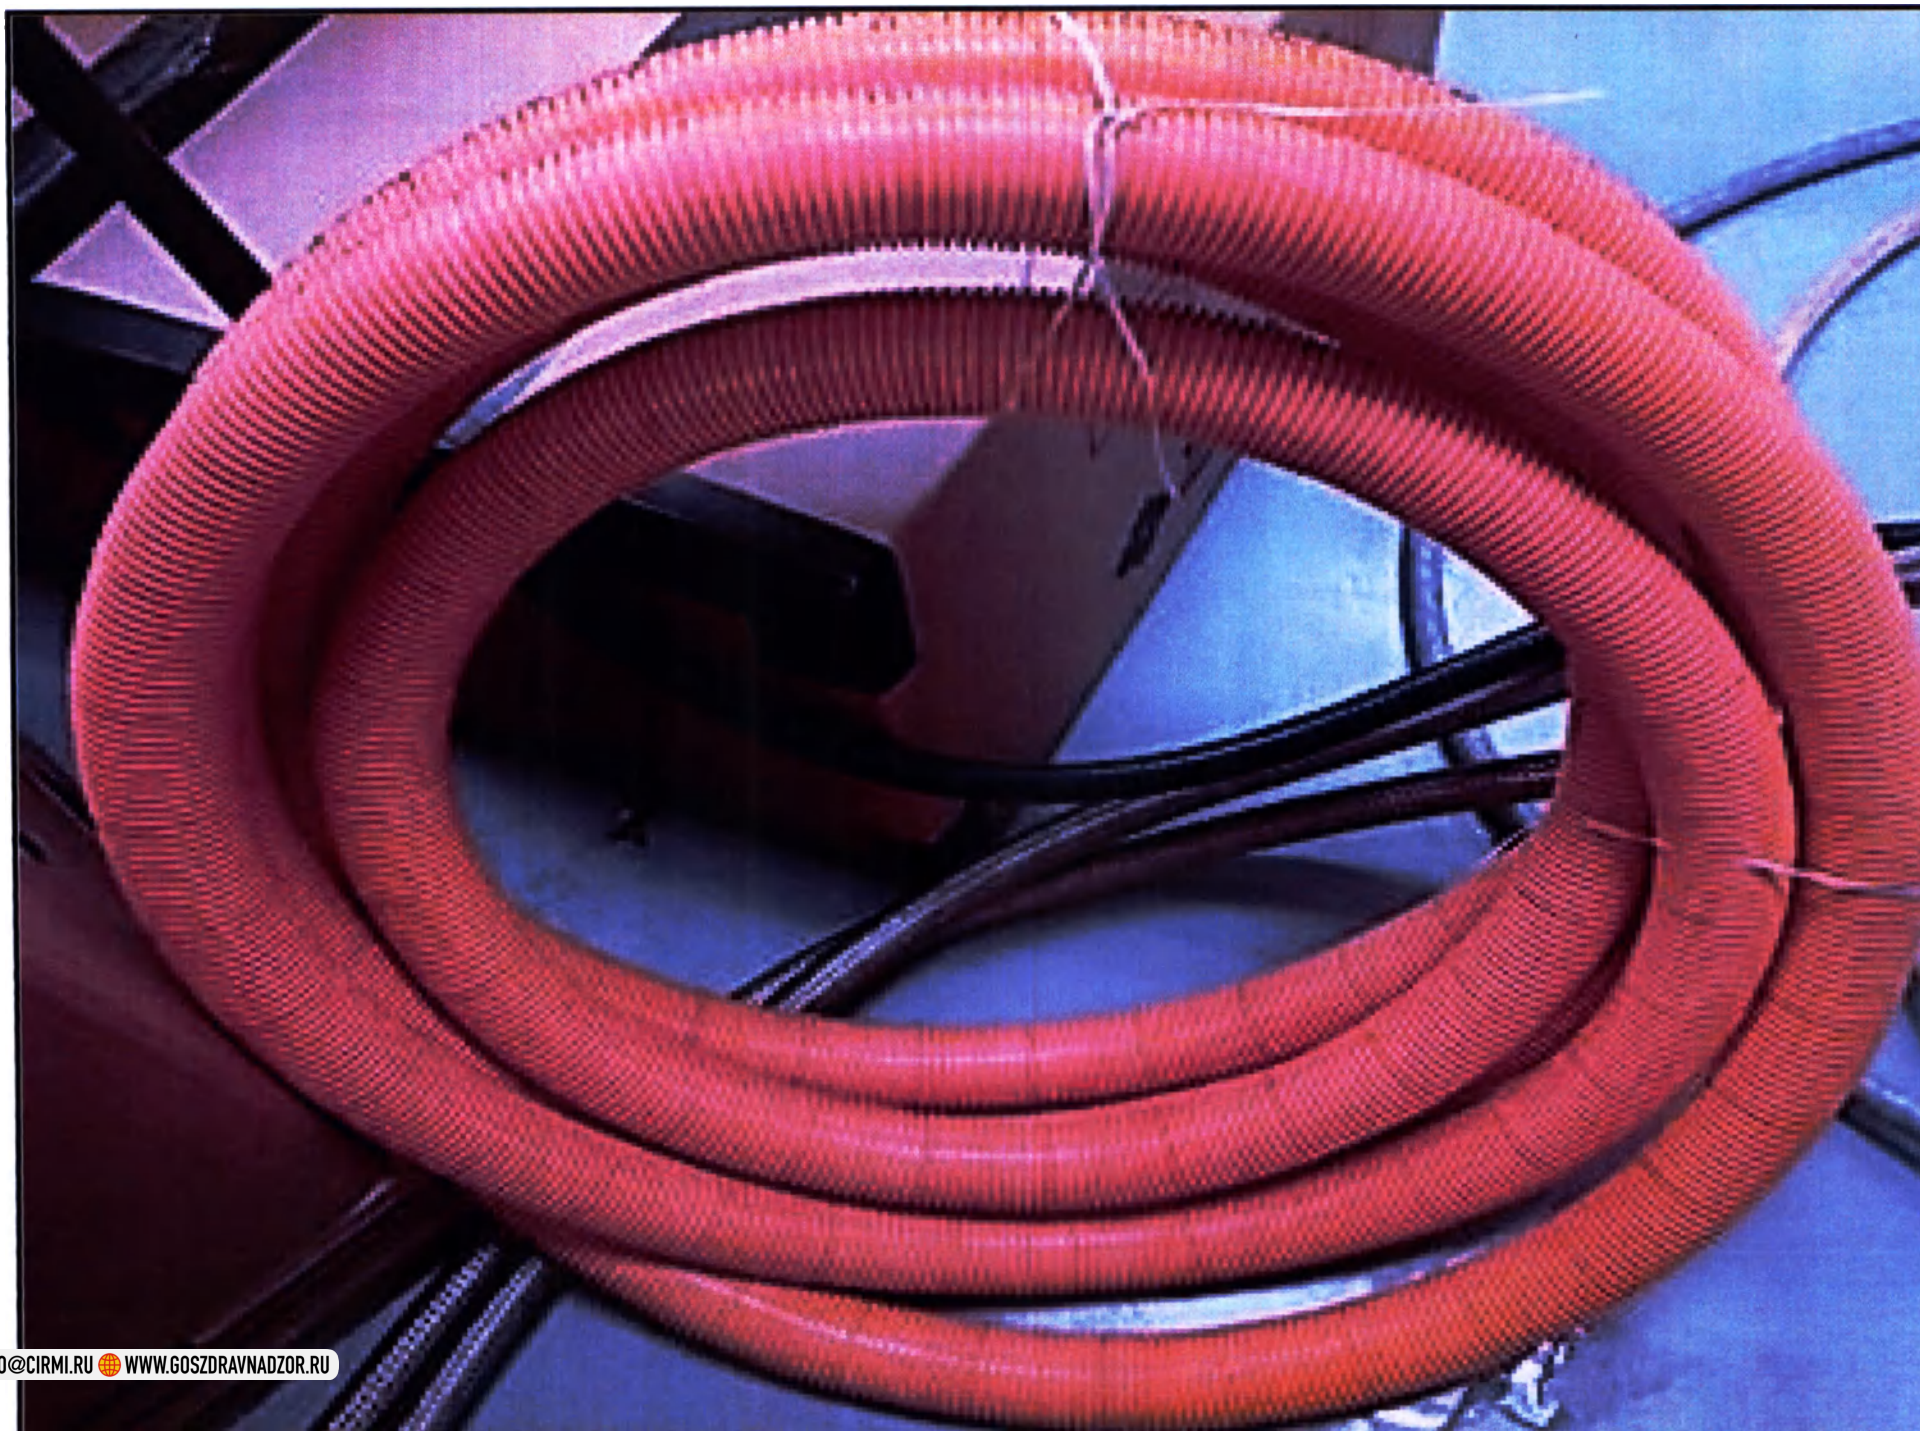

20. Кабели силовые (не более 200 шт.).



20. Кабели силовые (не более 200 шт.).




20. Кабели силовые (не более 200 шт.).



21. Кабели оптические (не более 100 шт.).




21. Кабели оптические (не более 100 шт.).

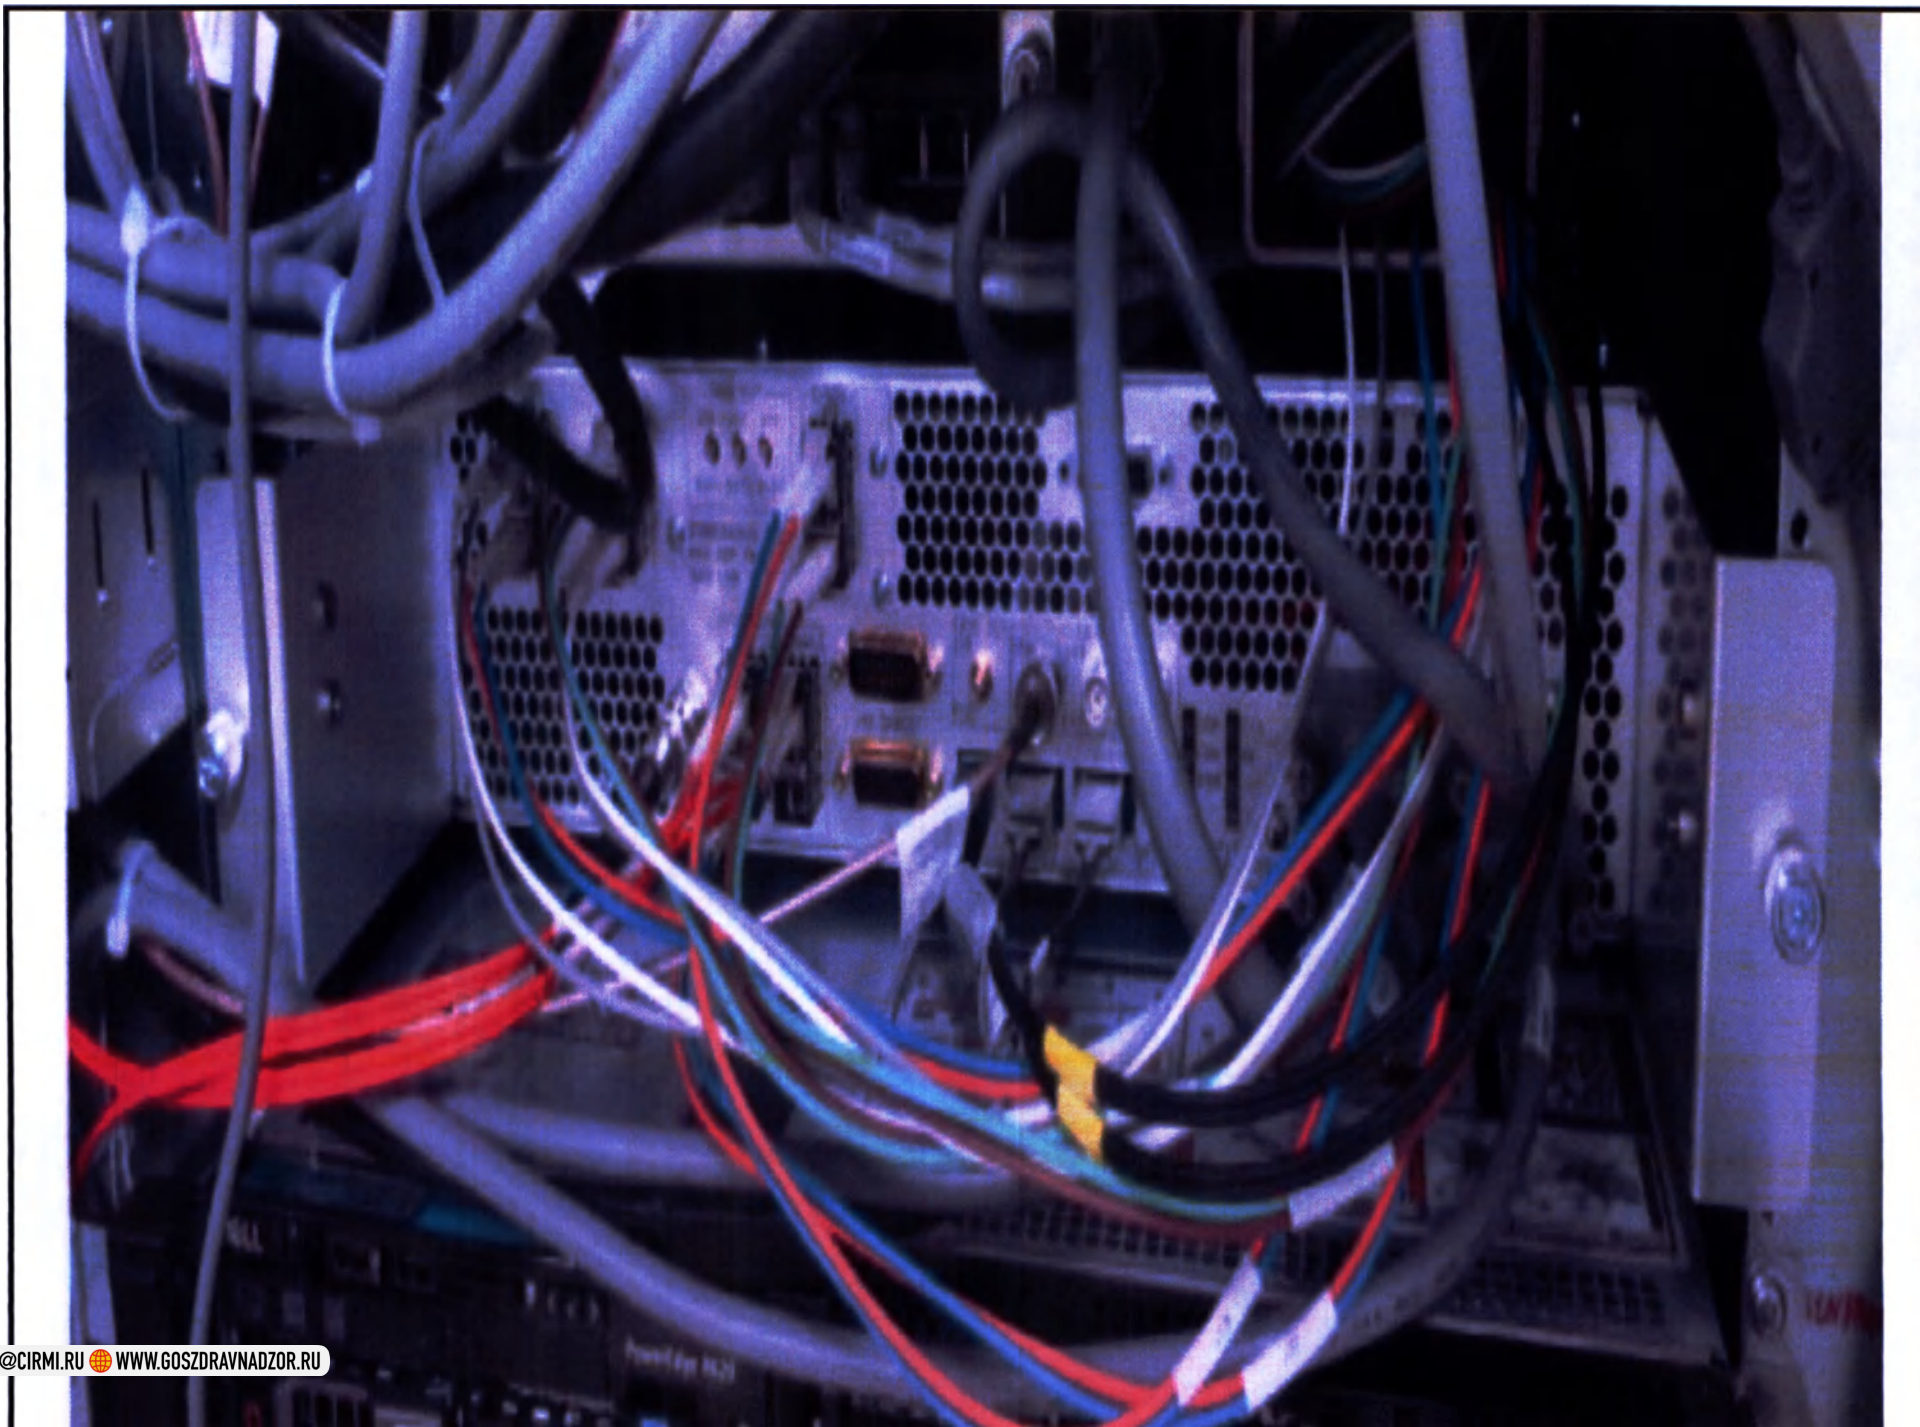


22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

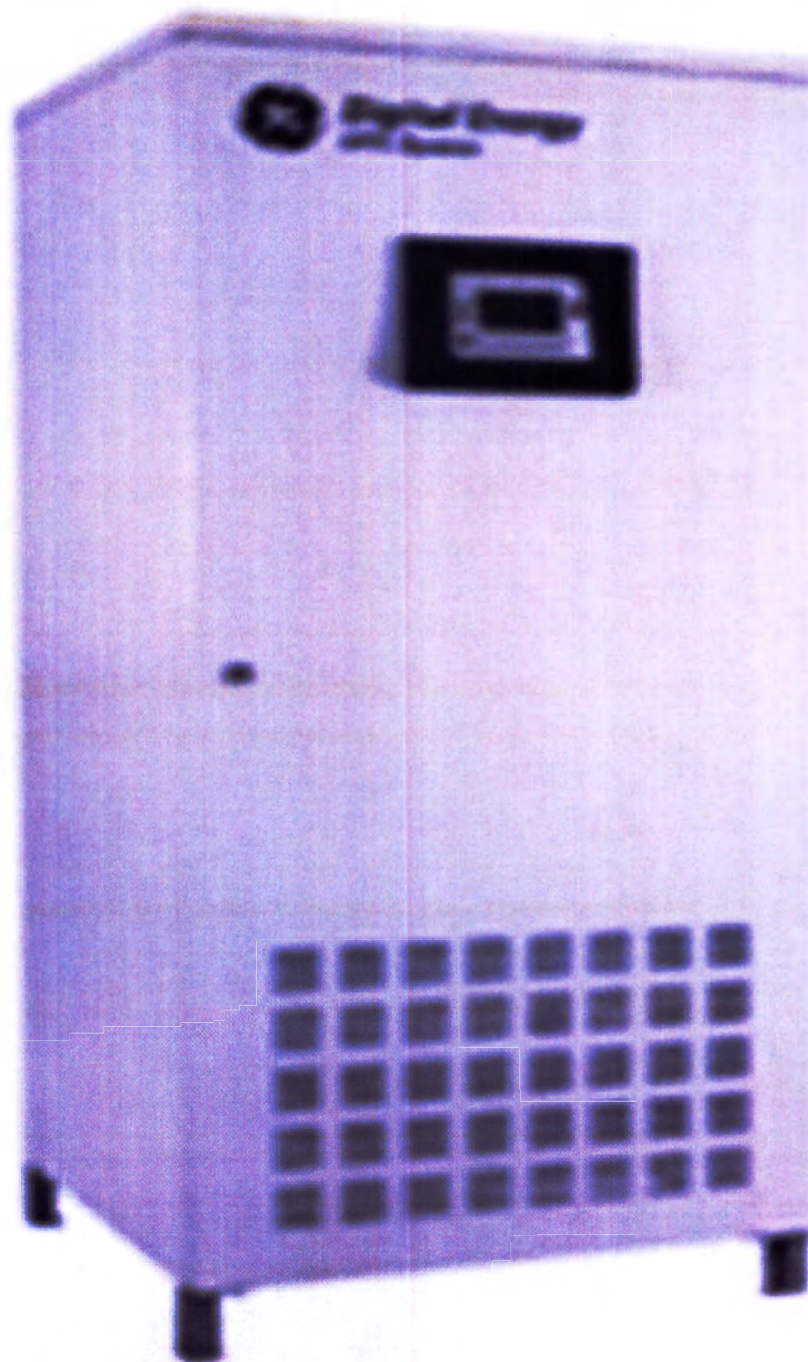

22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

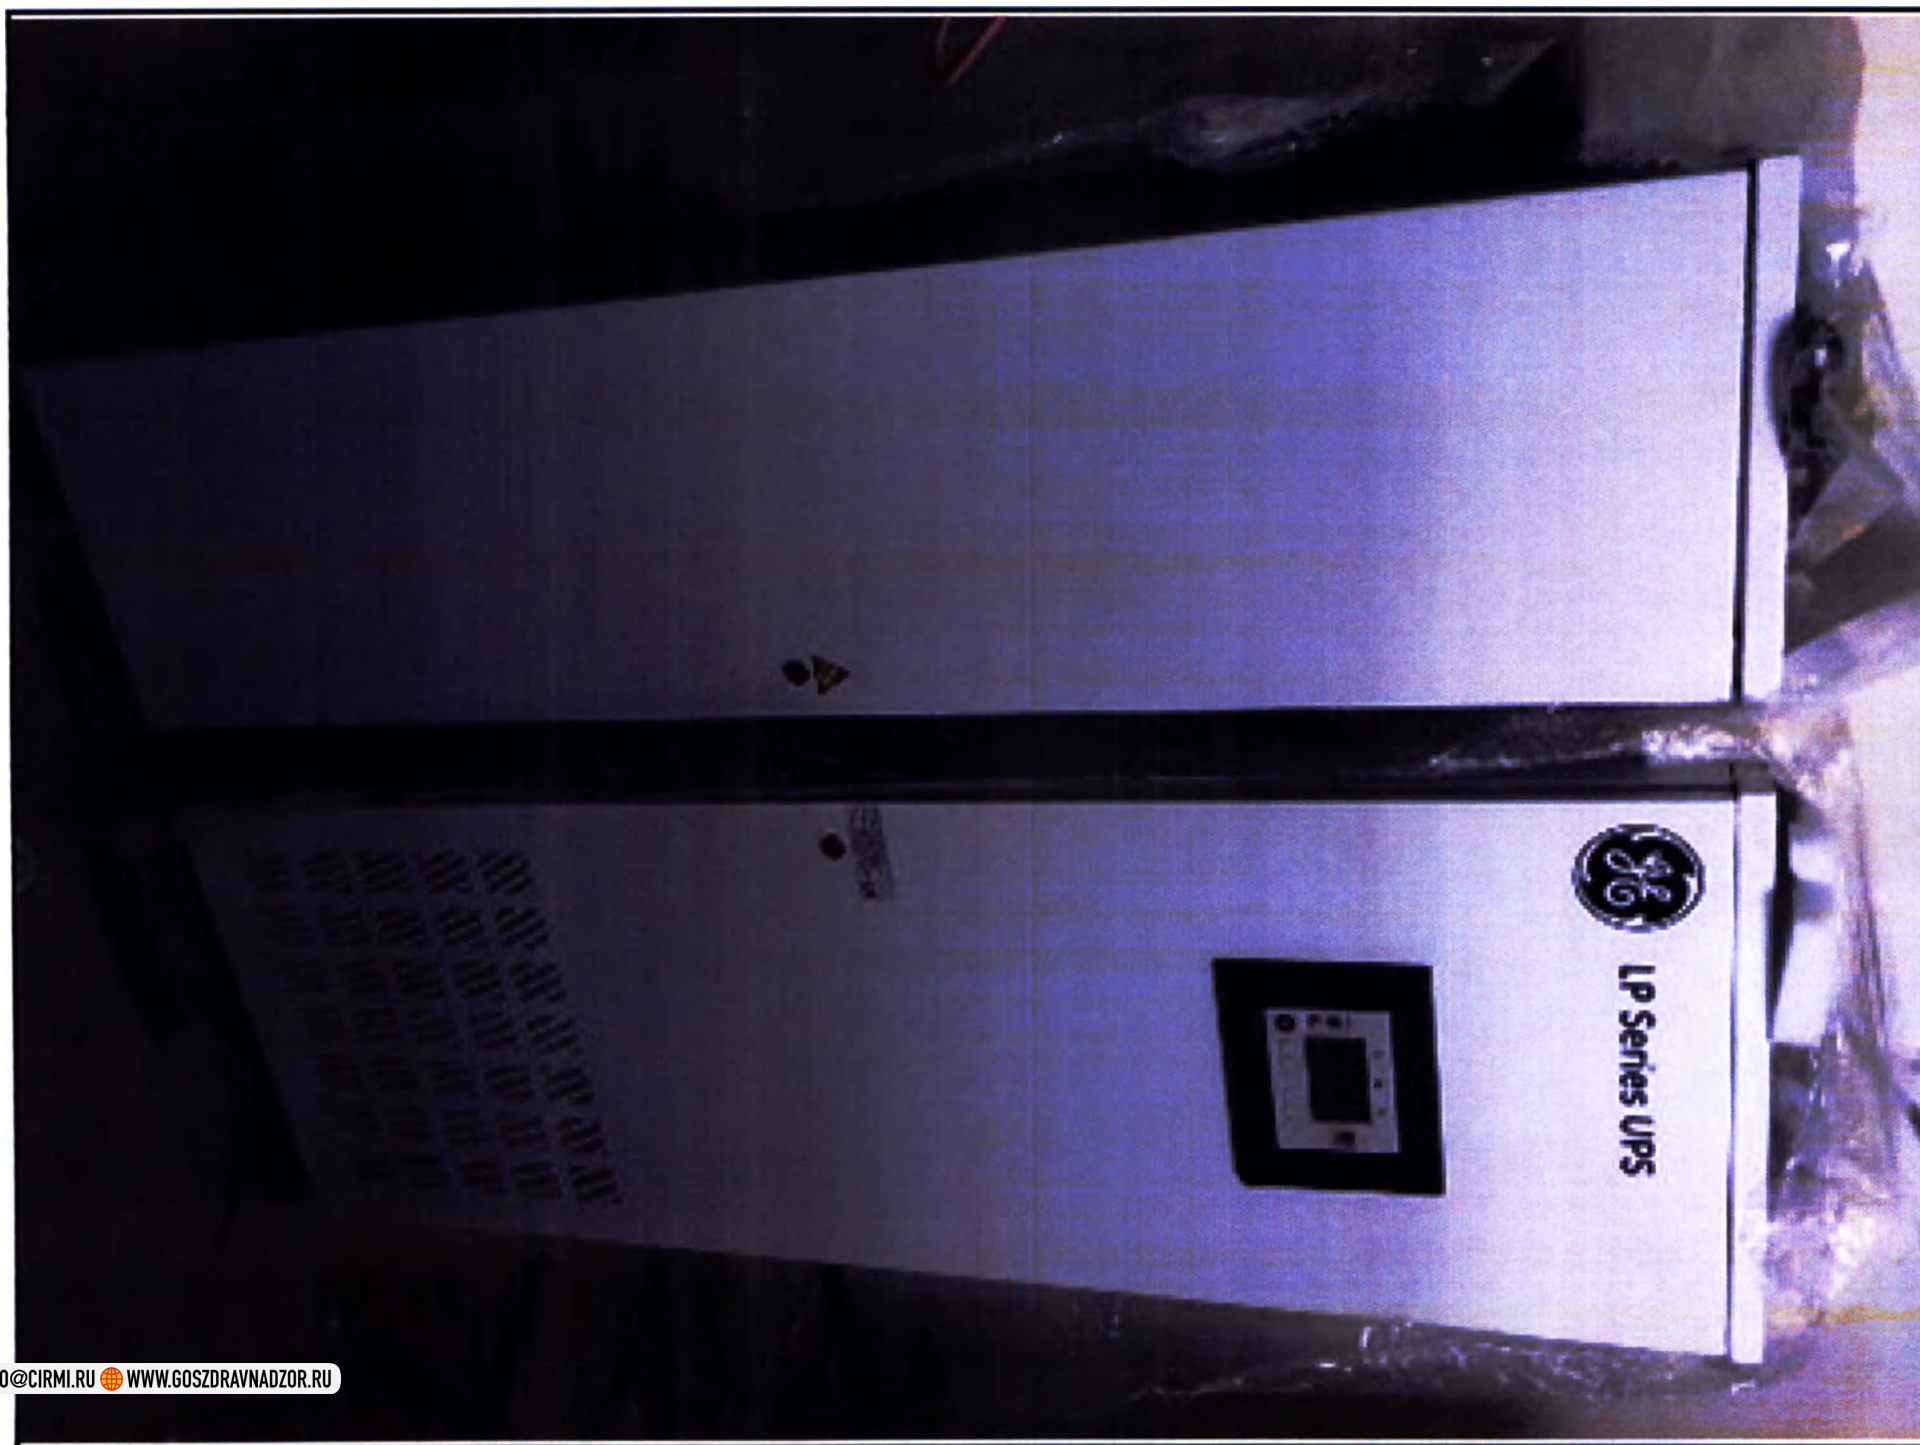

22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).



22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).




22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).




22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).




22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

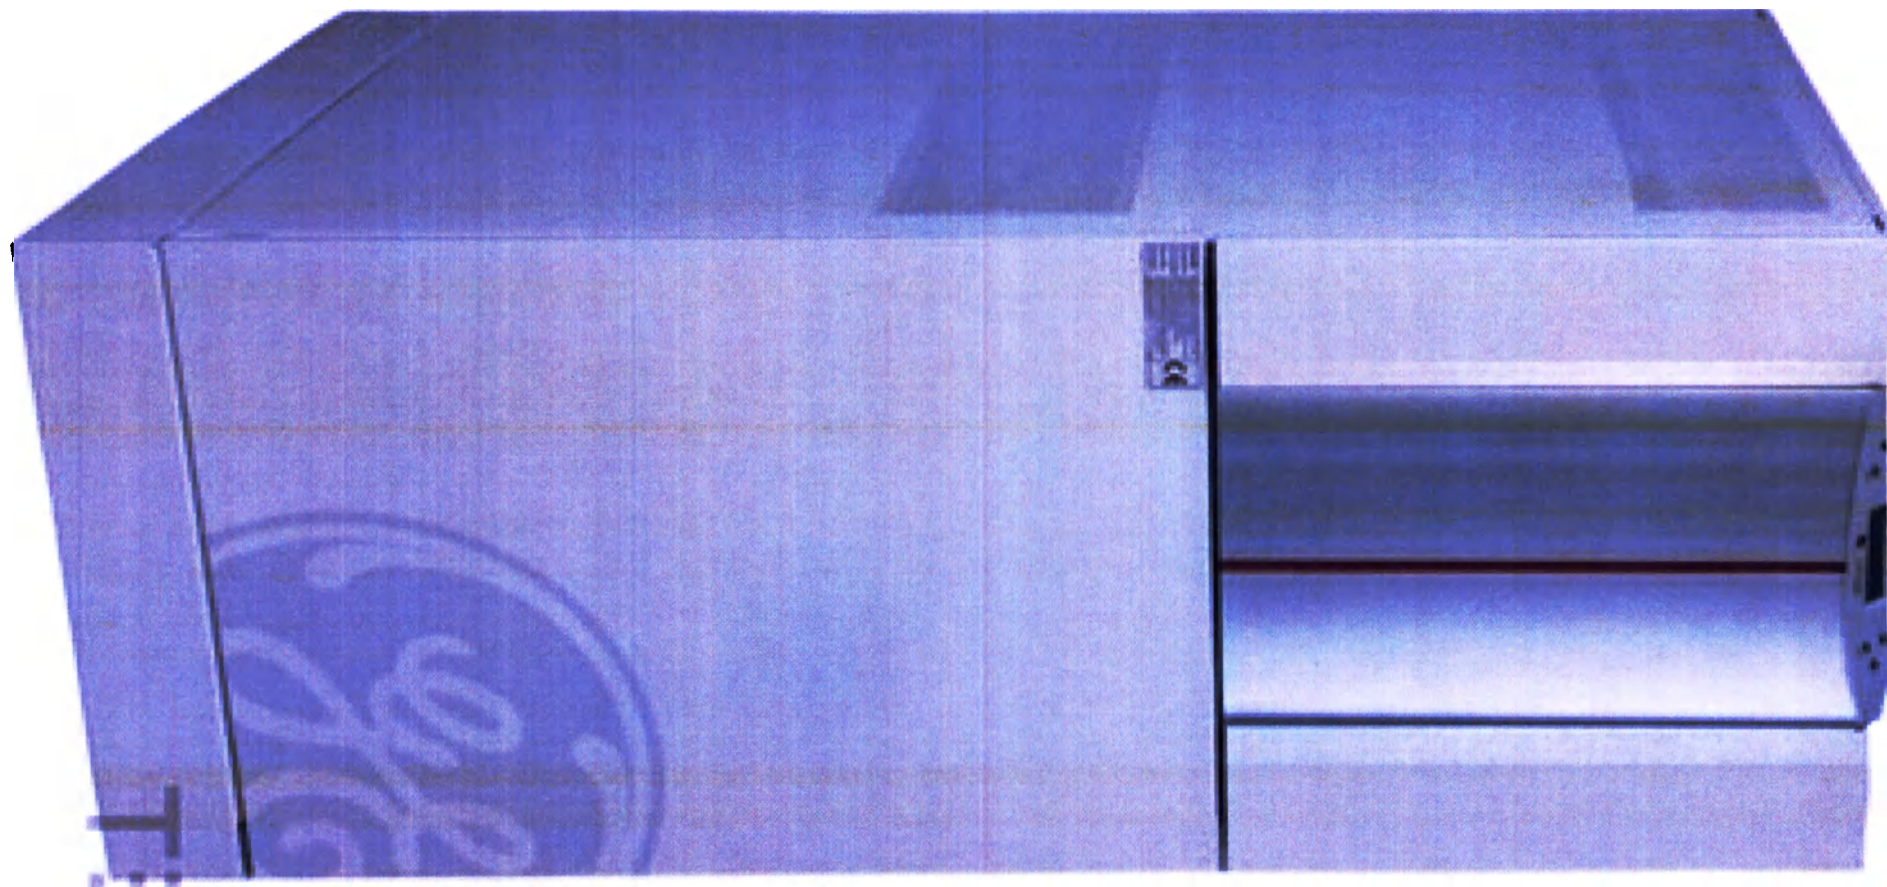


22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

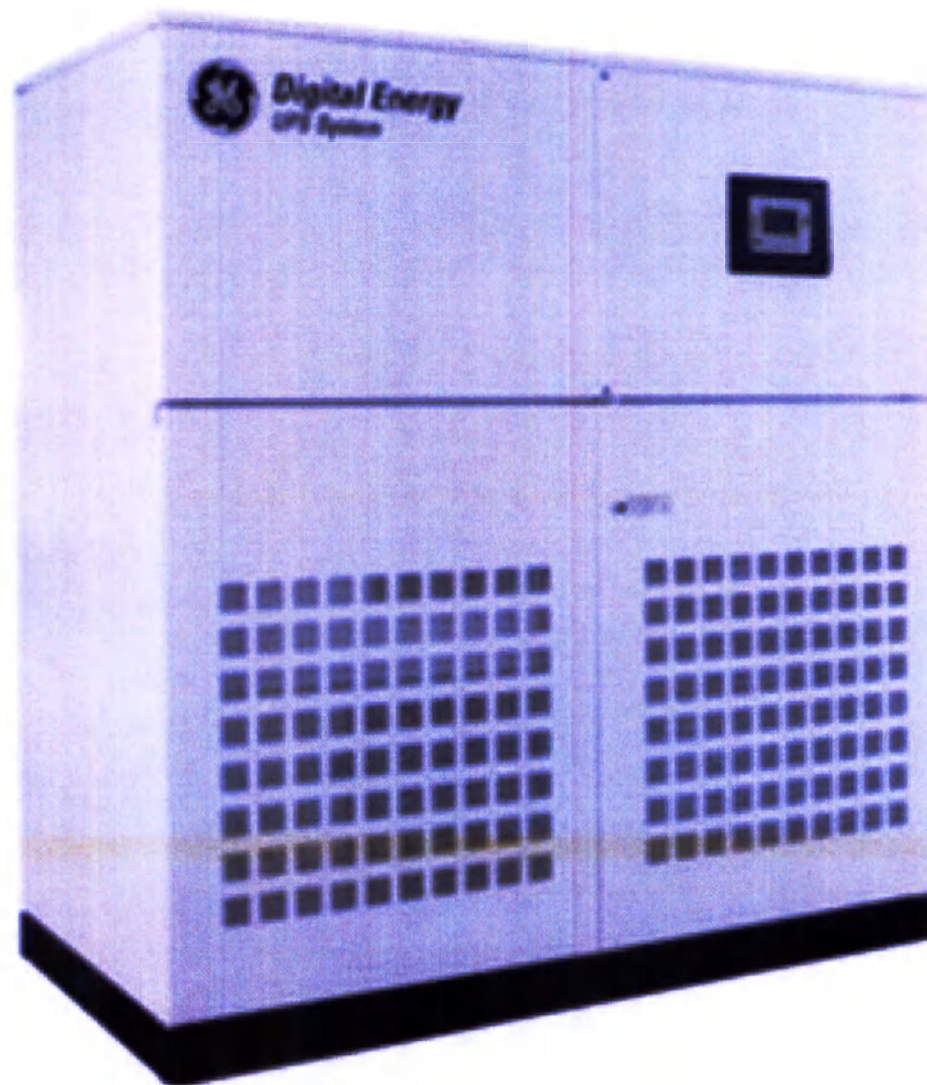

22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

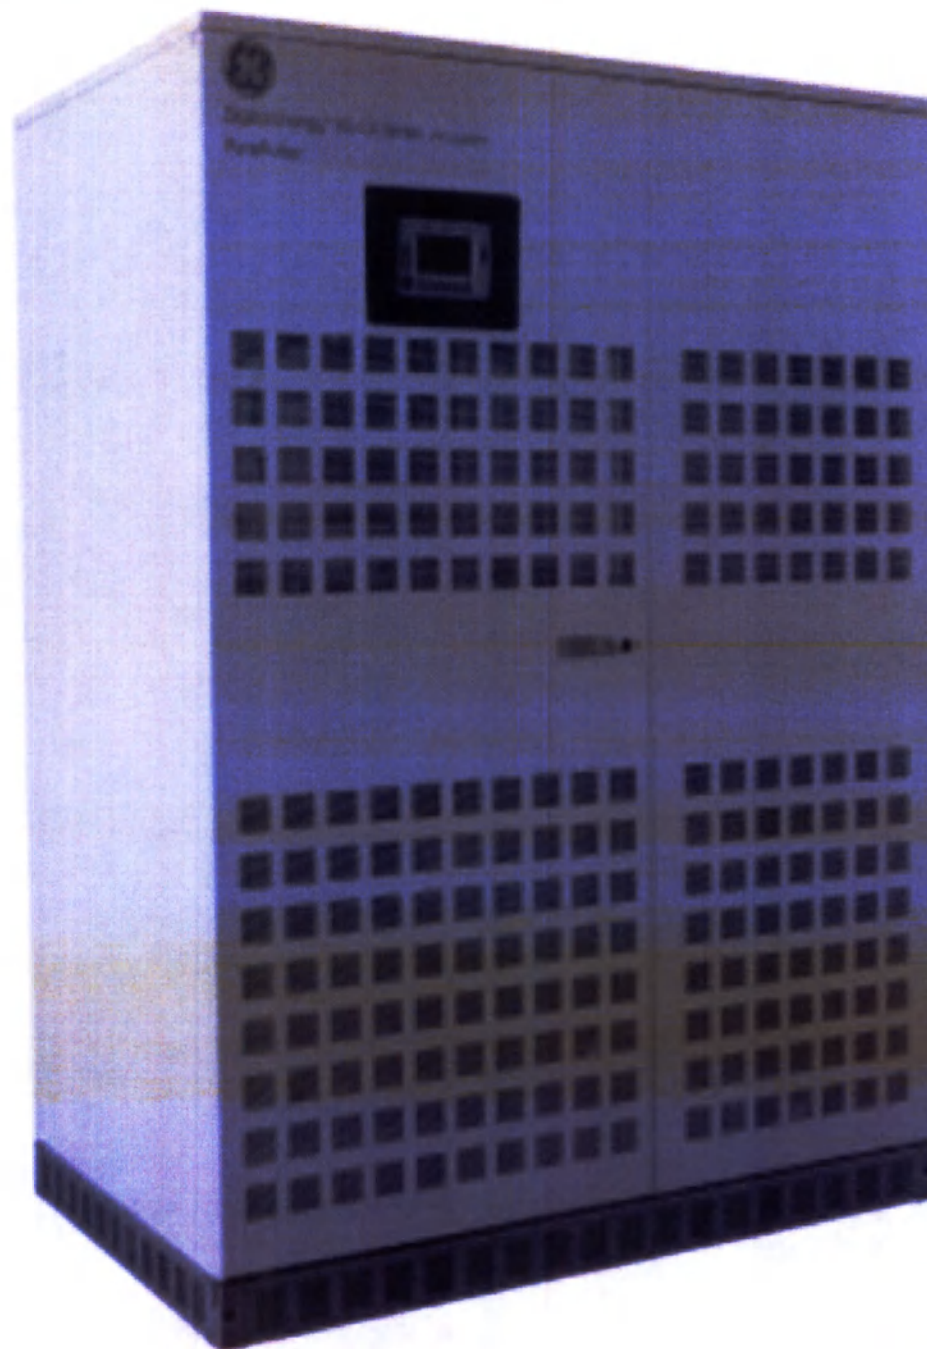

22. Источники бесперебойного питания (не более 5 шт.).

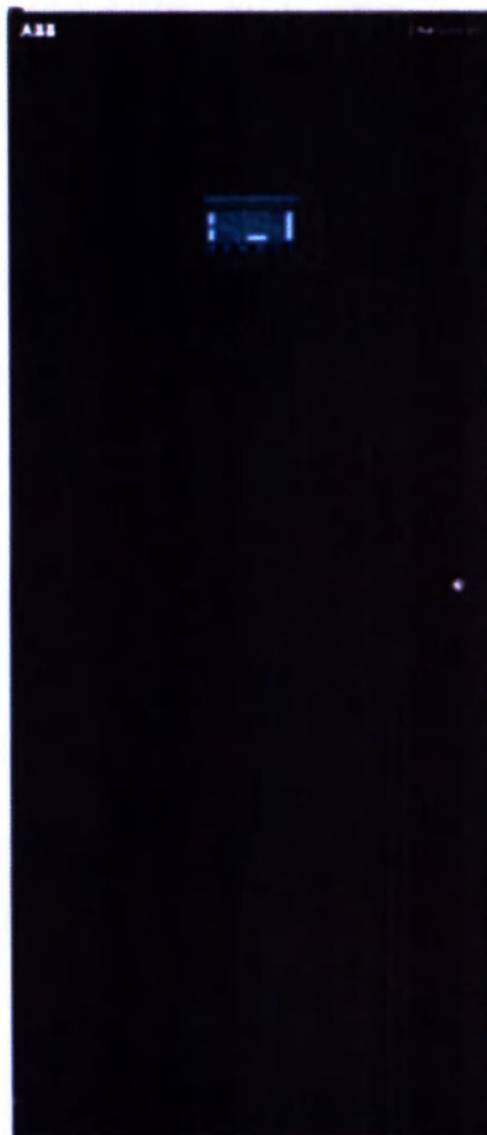


23. Принтер медицинский (не более 5 шт.).



23. Принтер медицинский (не более 5 шт.).







24. Термобумага (не более 500 шт.).



24. Термобумага (не более 500 шт.).

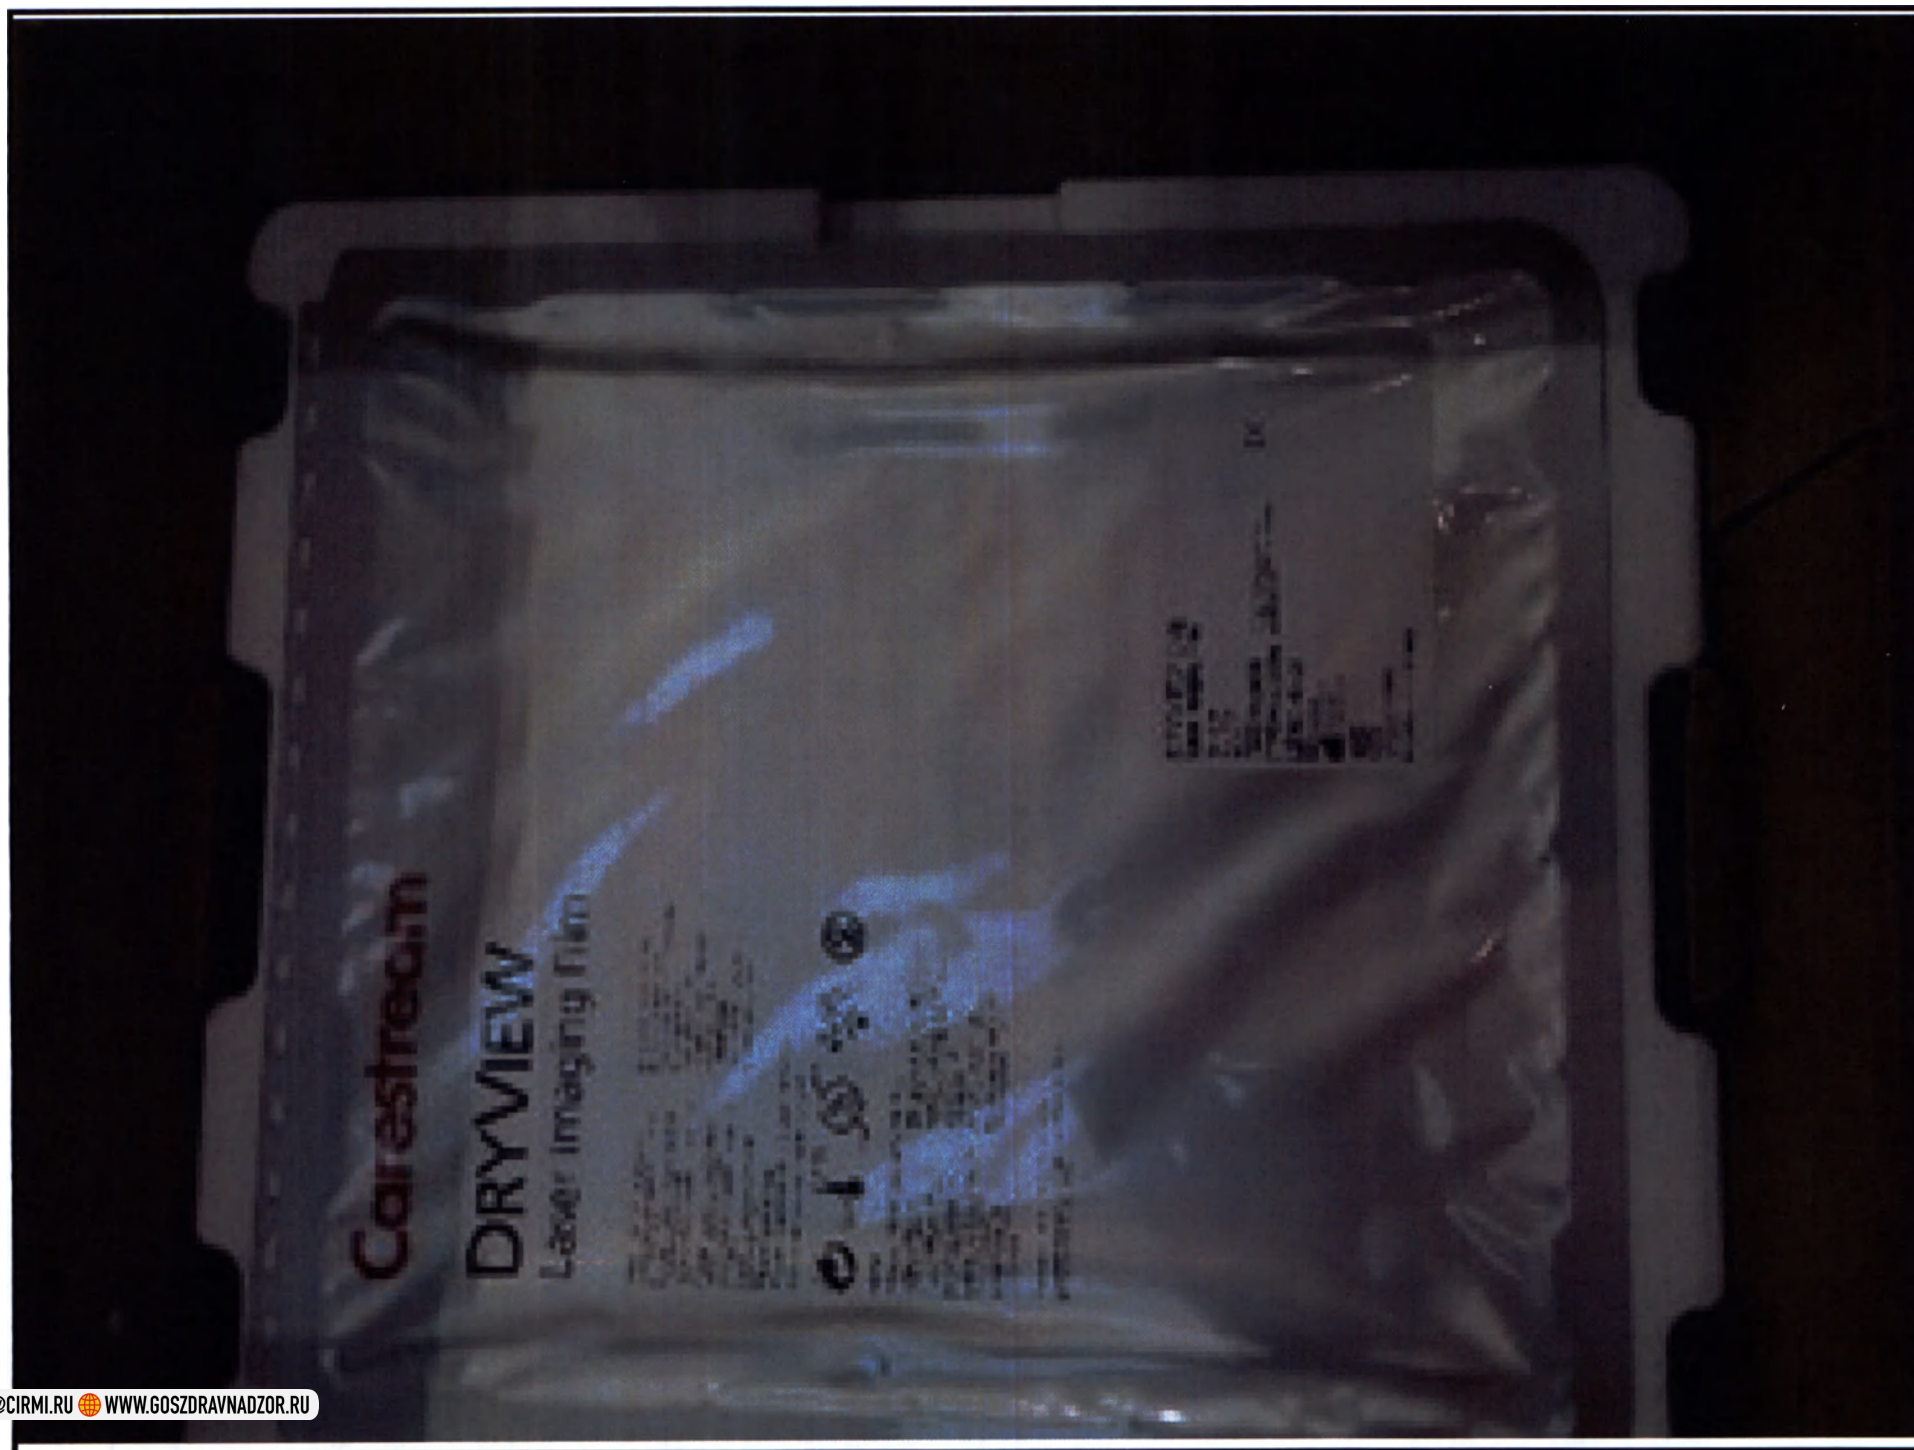


24. Термобумага (не более 500 шт.).

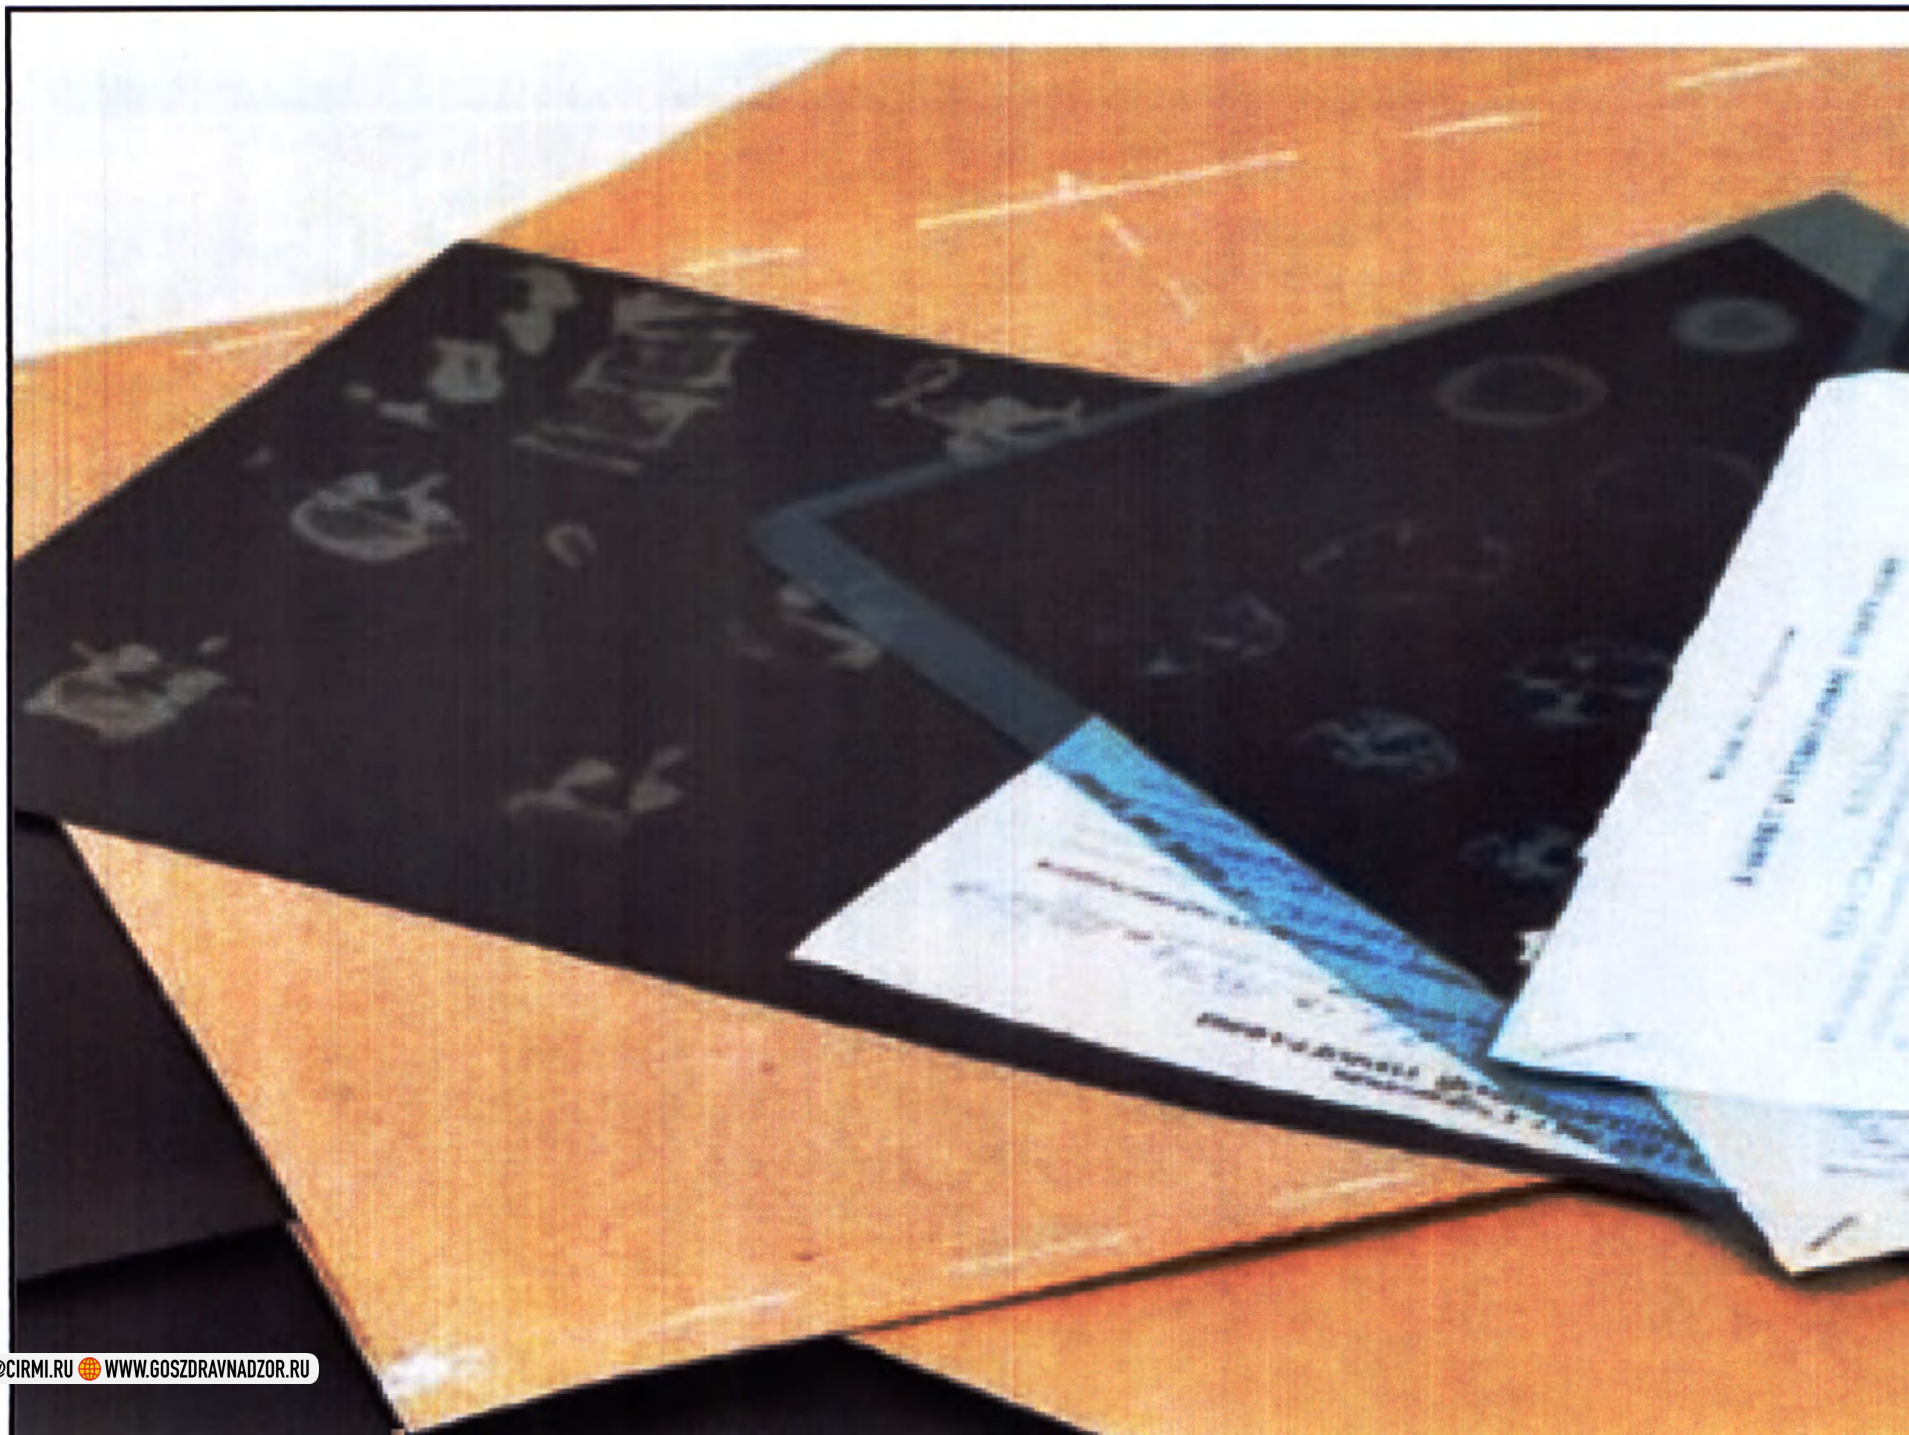

25. Мониторы кислорода (не более 5 шт.).



25. Мониторы кислорода (не более 5 шт.).

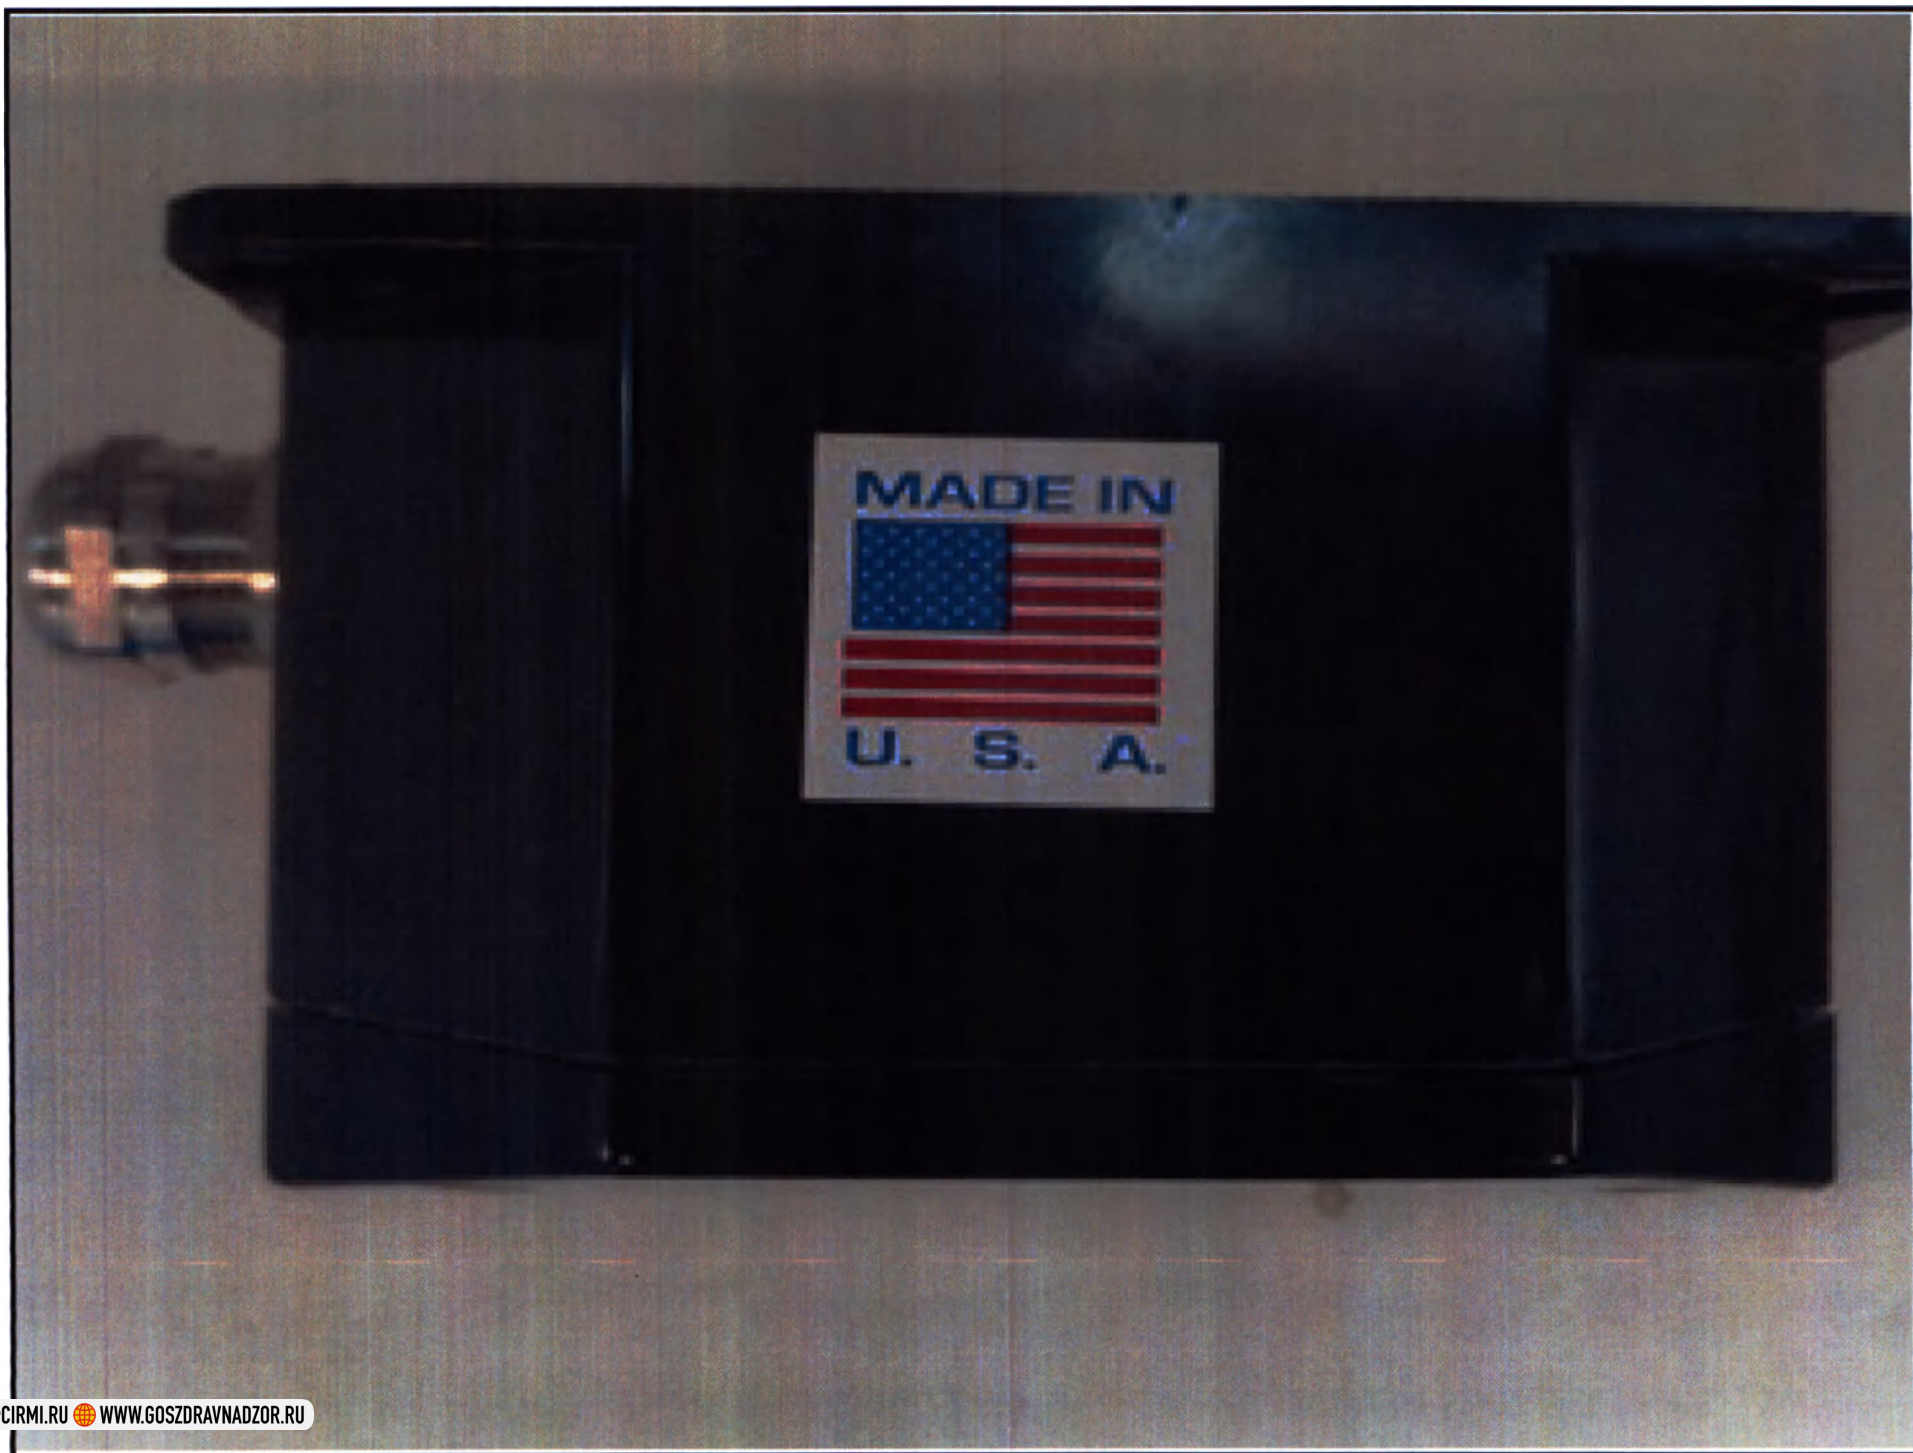


25. Мониторы кислорода (не более 5 шт.).




25. Мониторы кислорода (не более 5 шт.).




26. Щит силовой распределительный (не более 5 шт.).

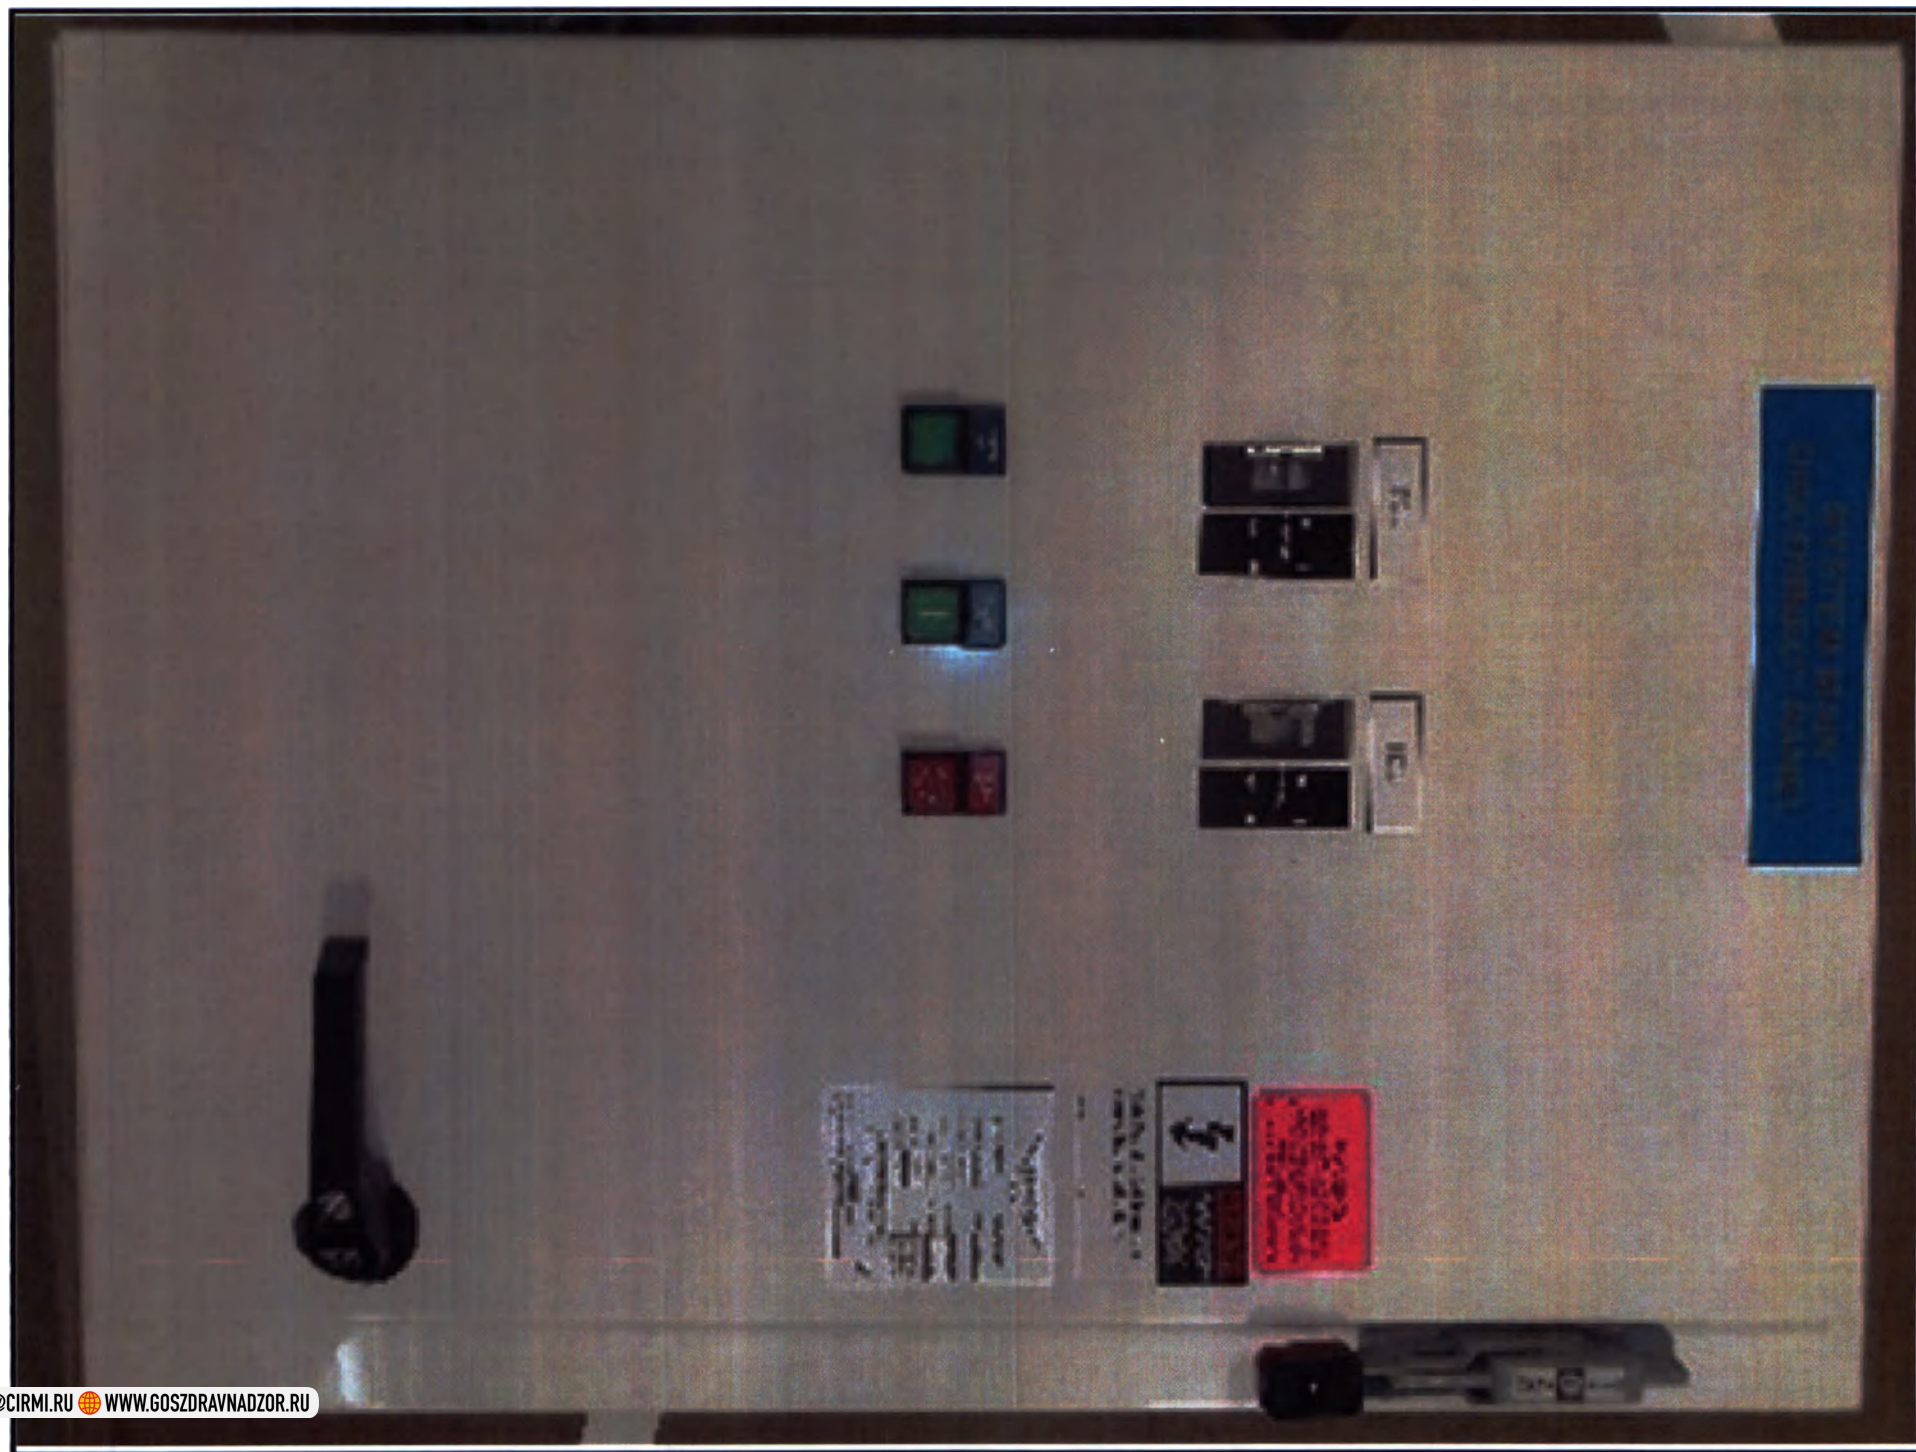


26. Щит силовой распределительный (не более 5 шт.).

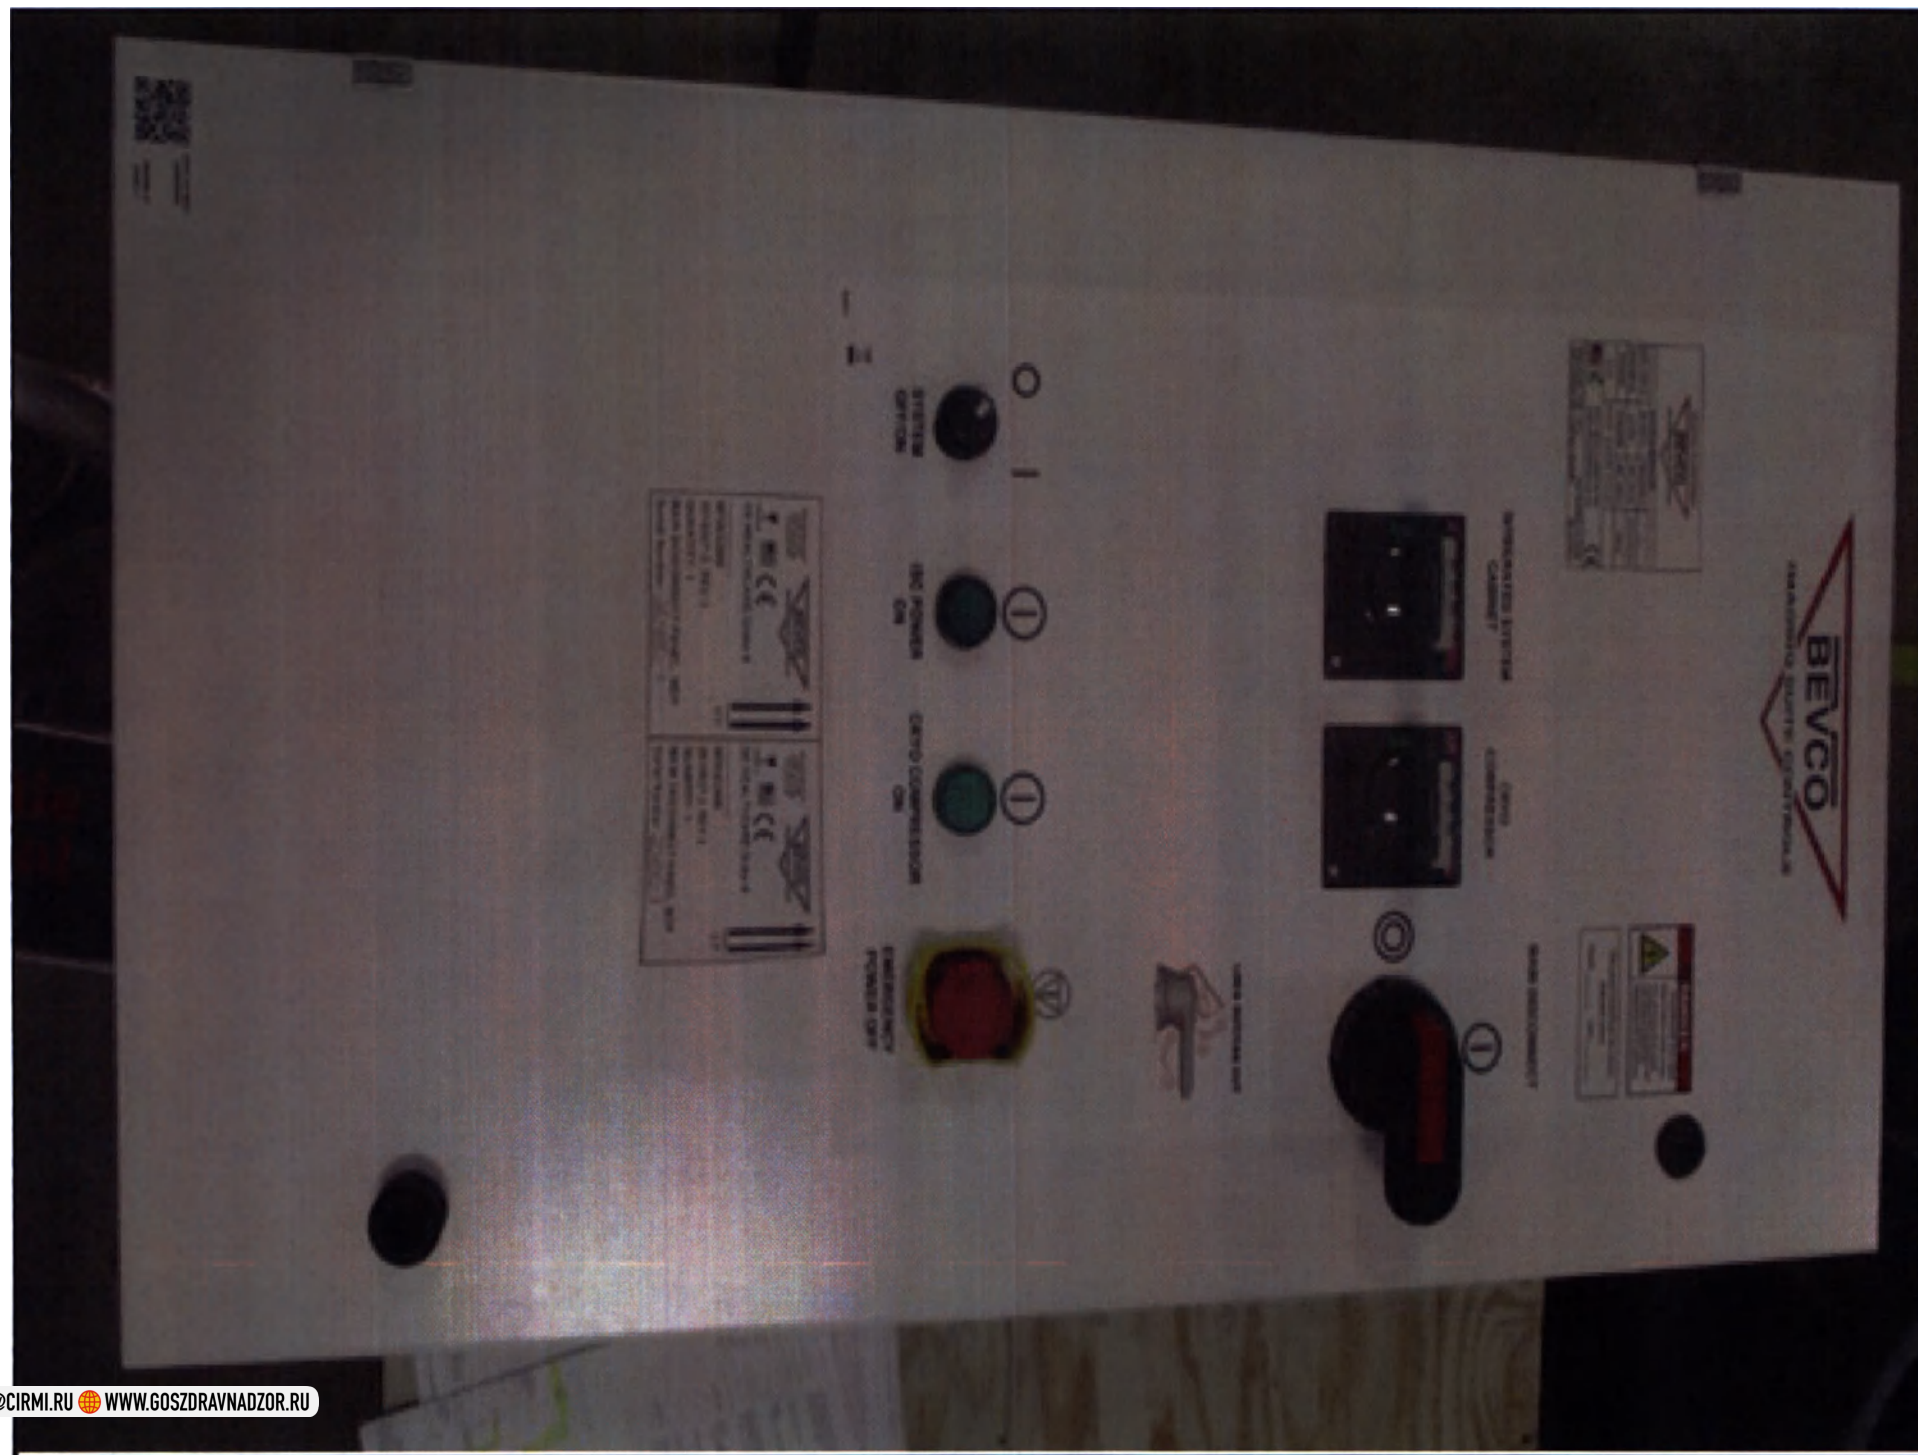


27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

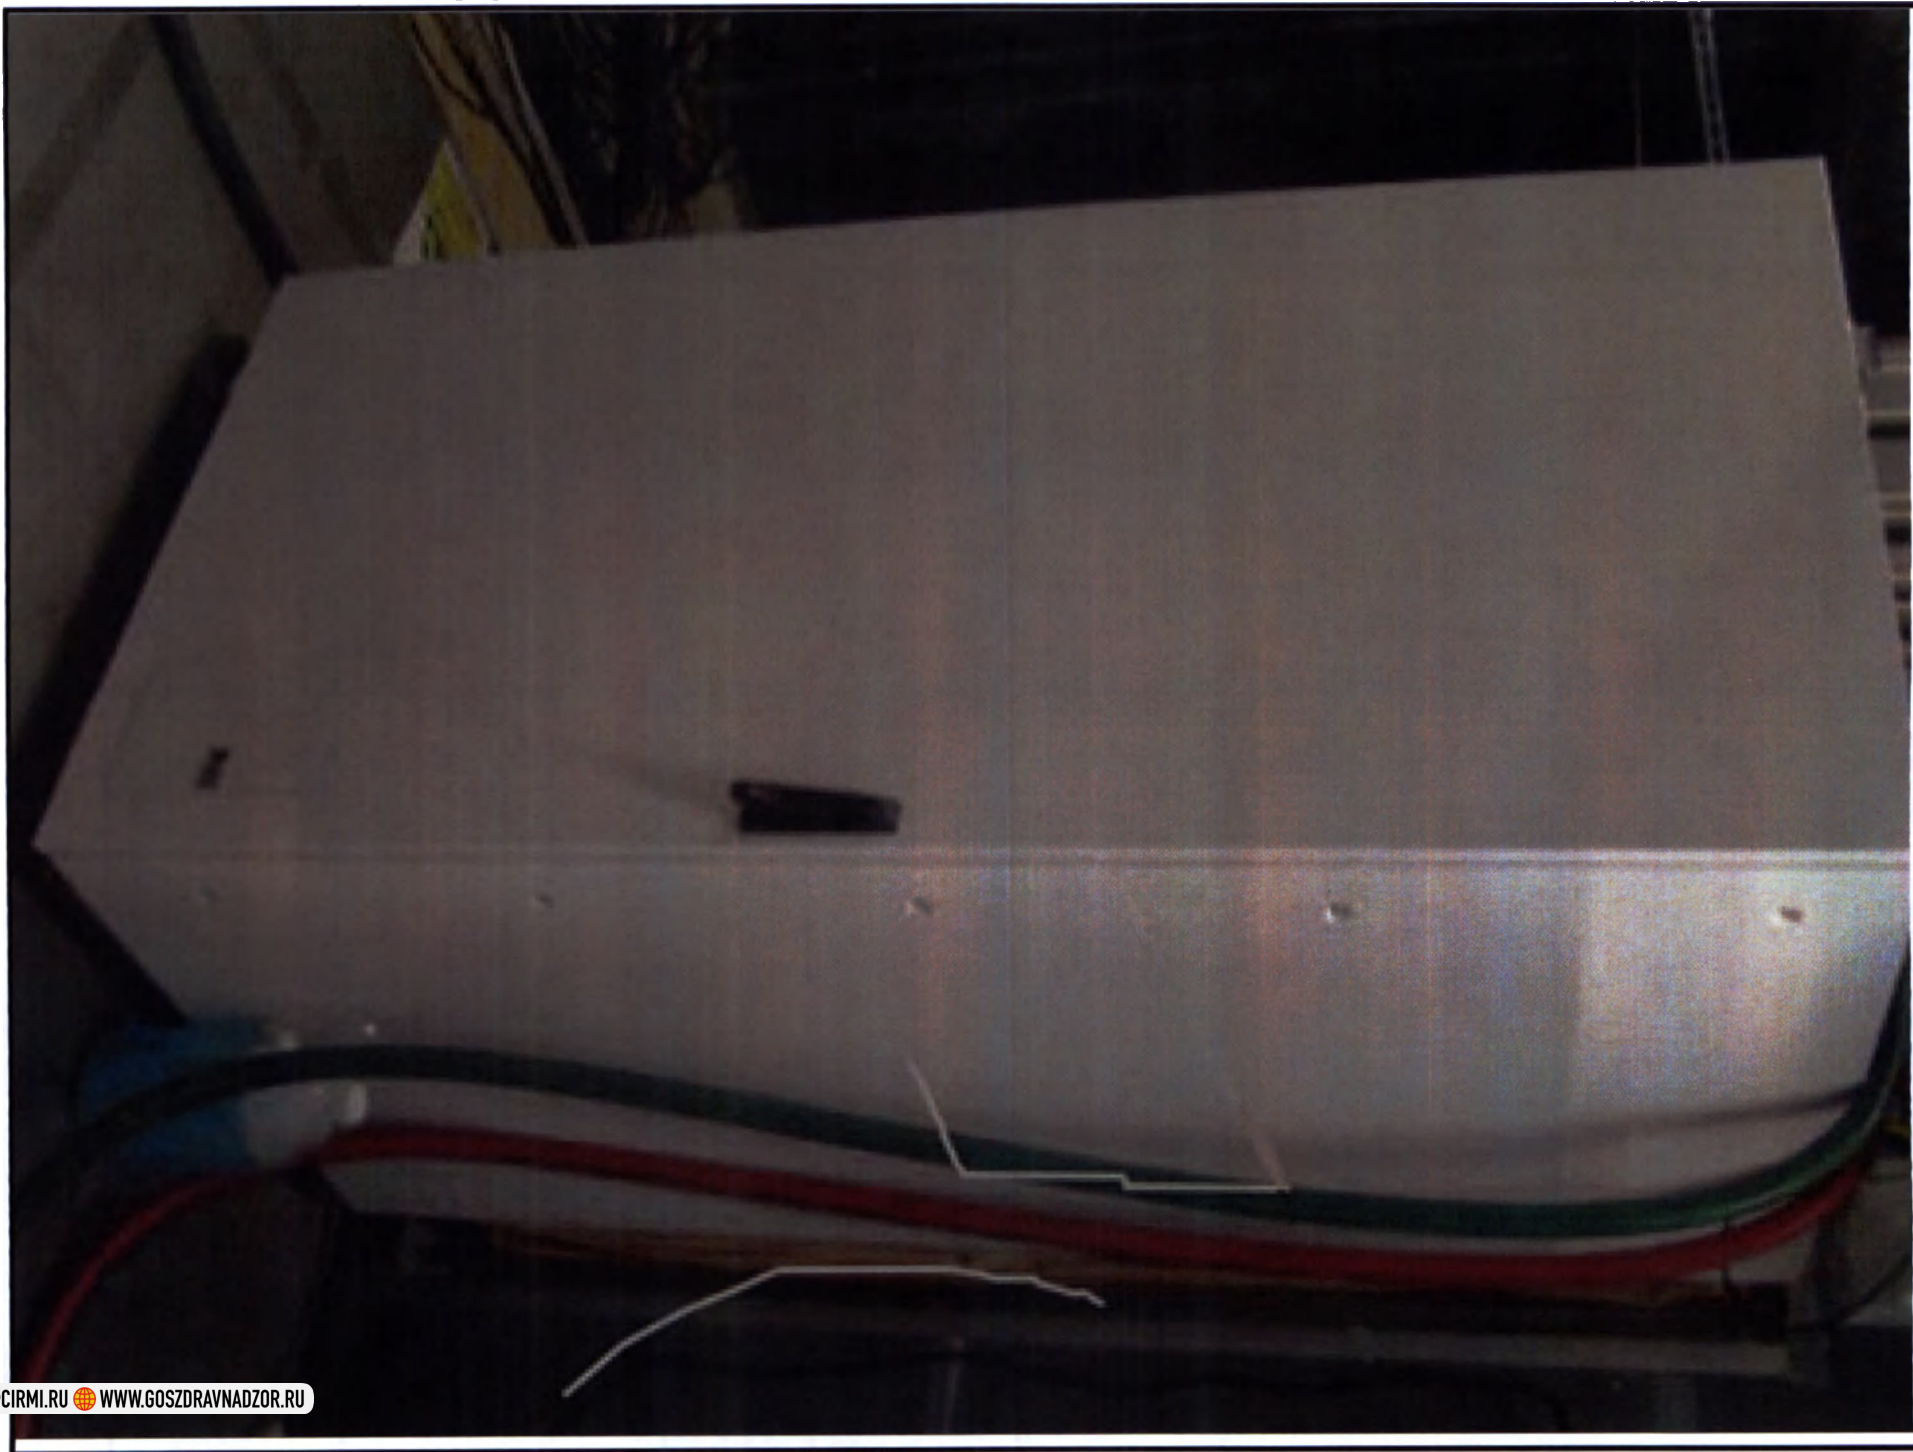


27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

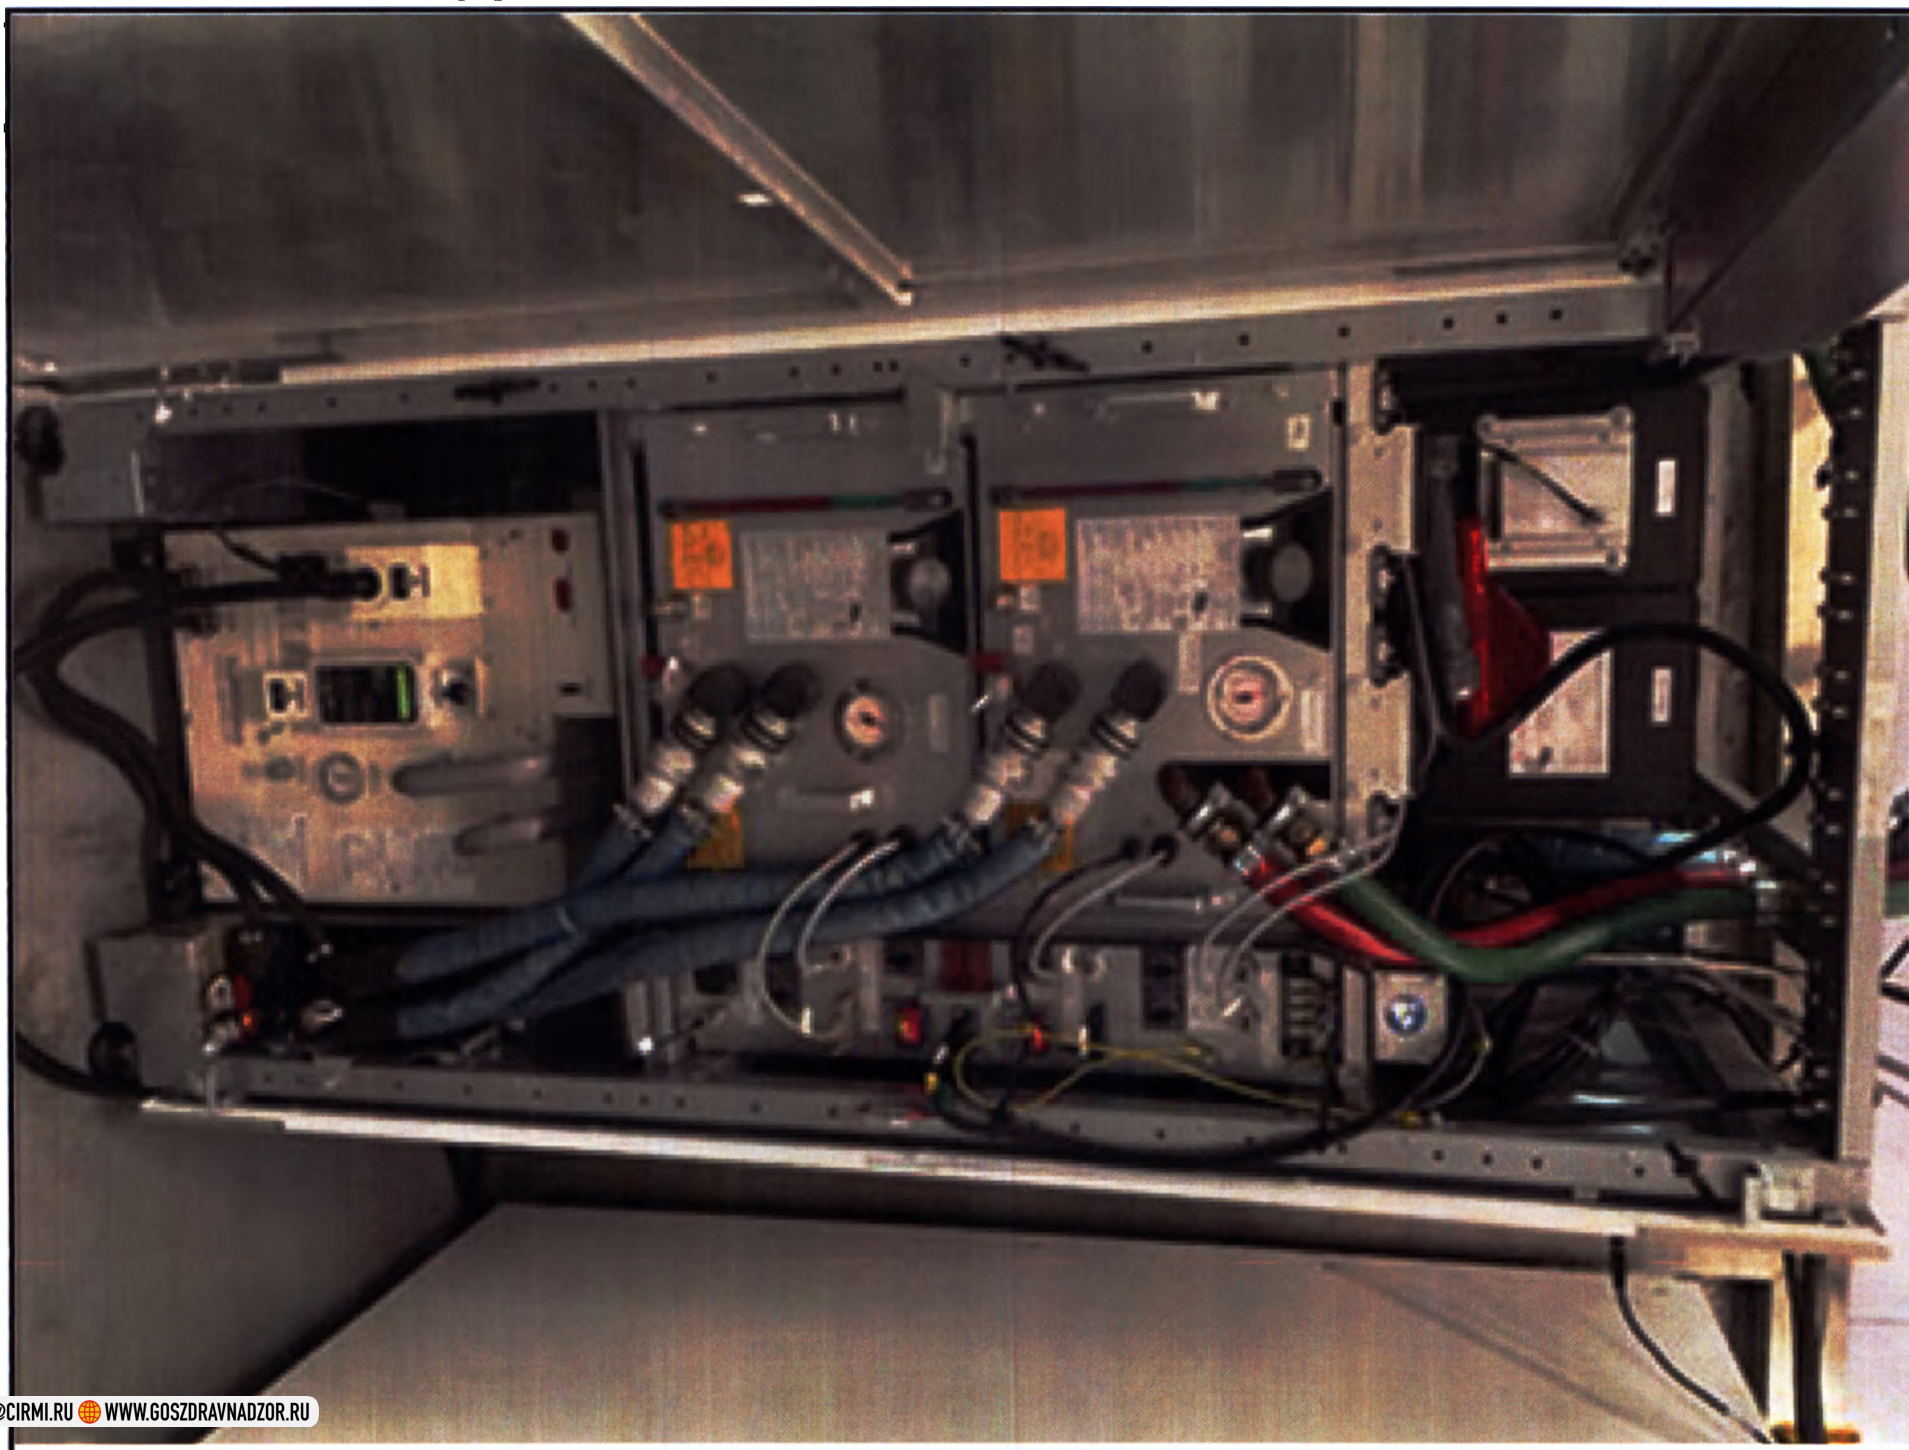


27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

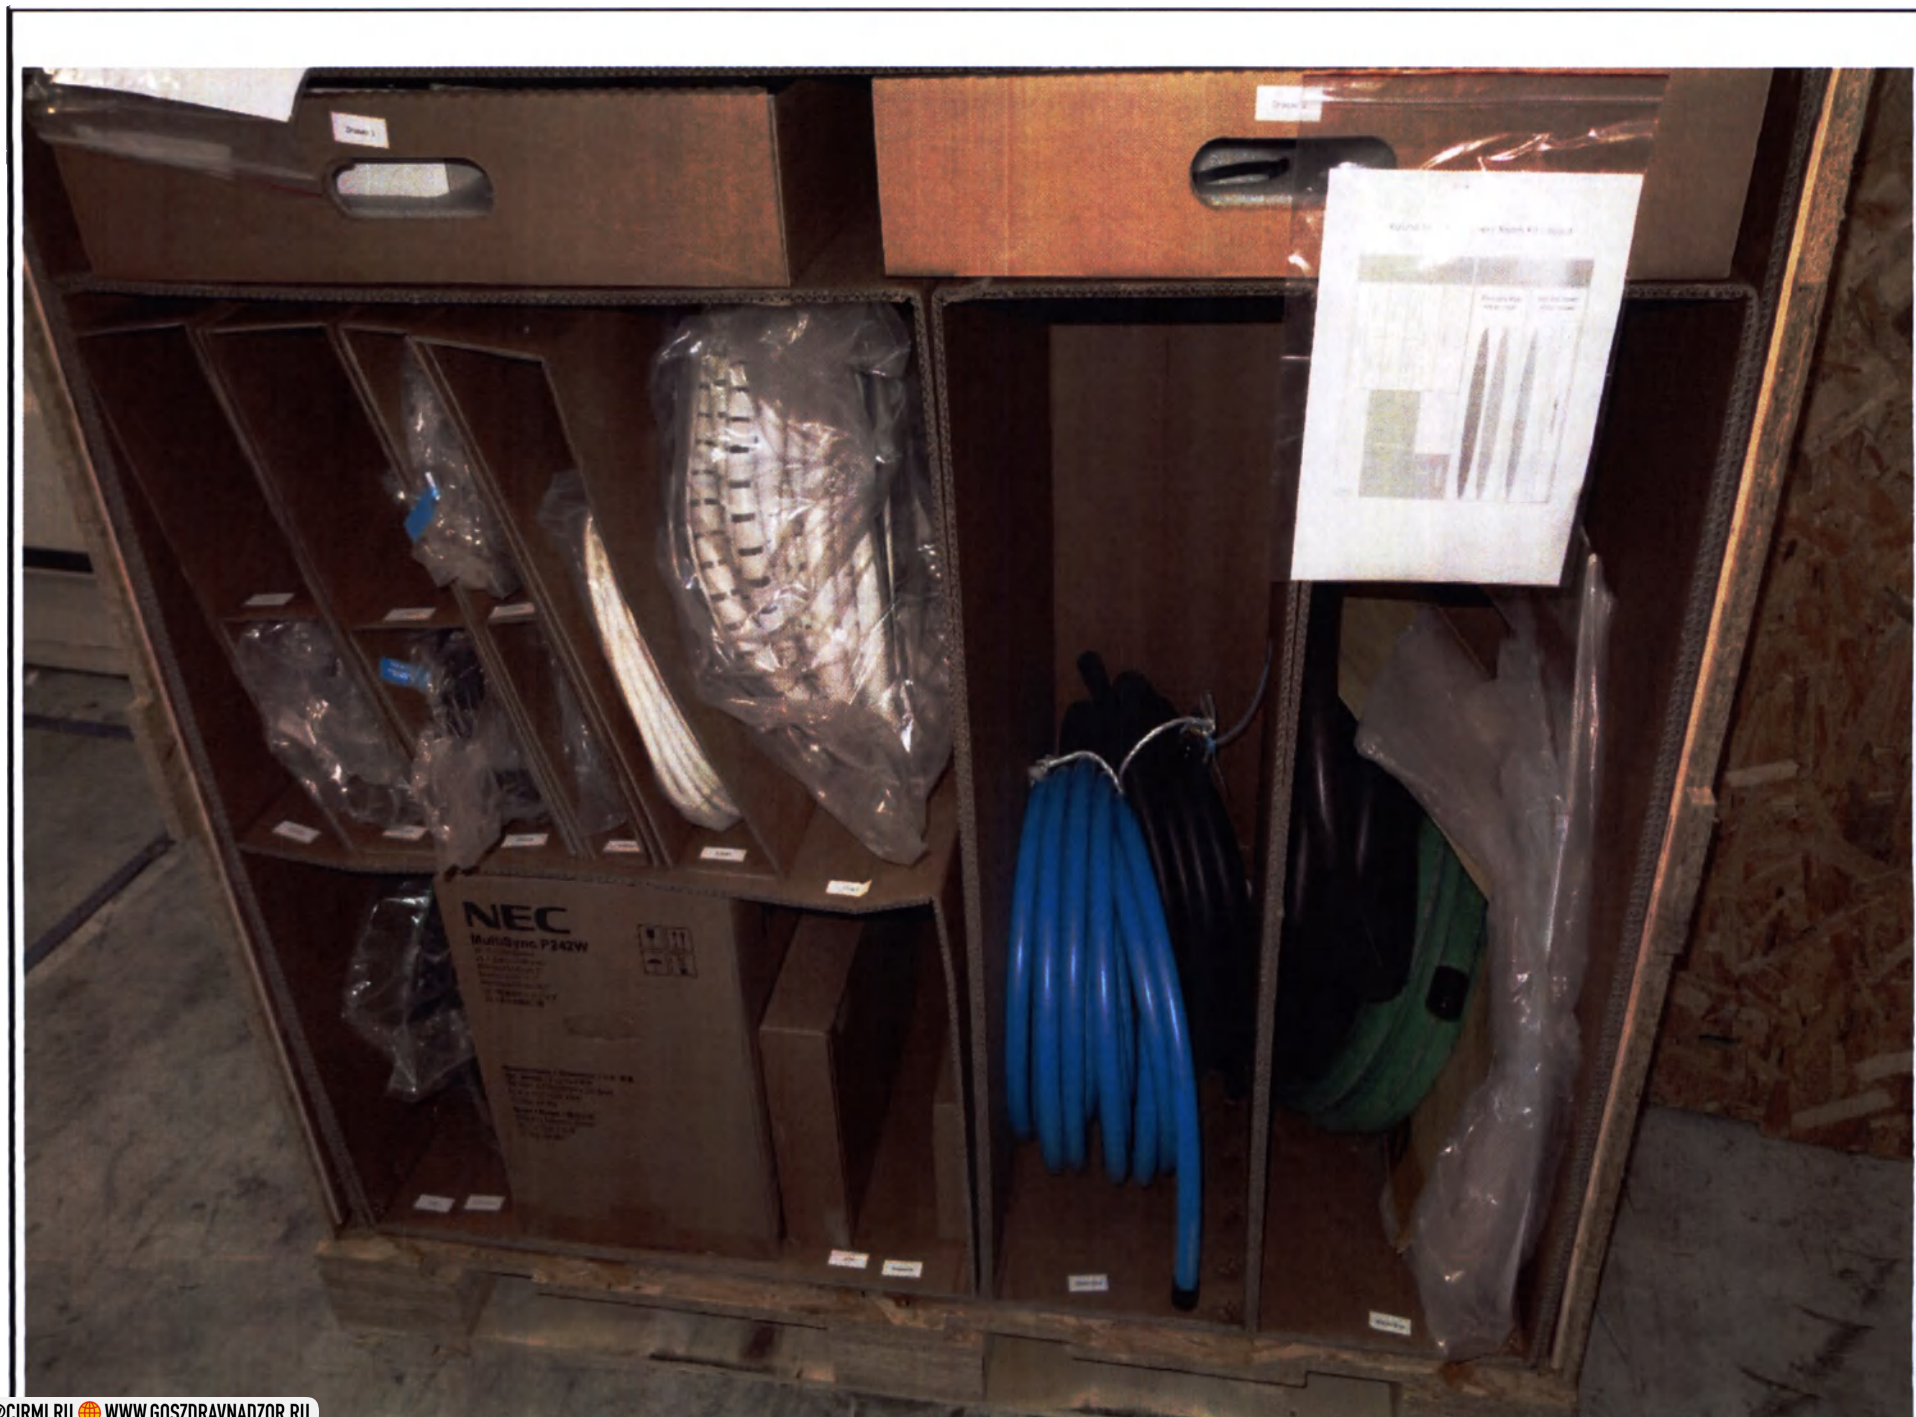

27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

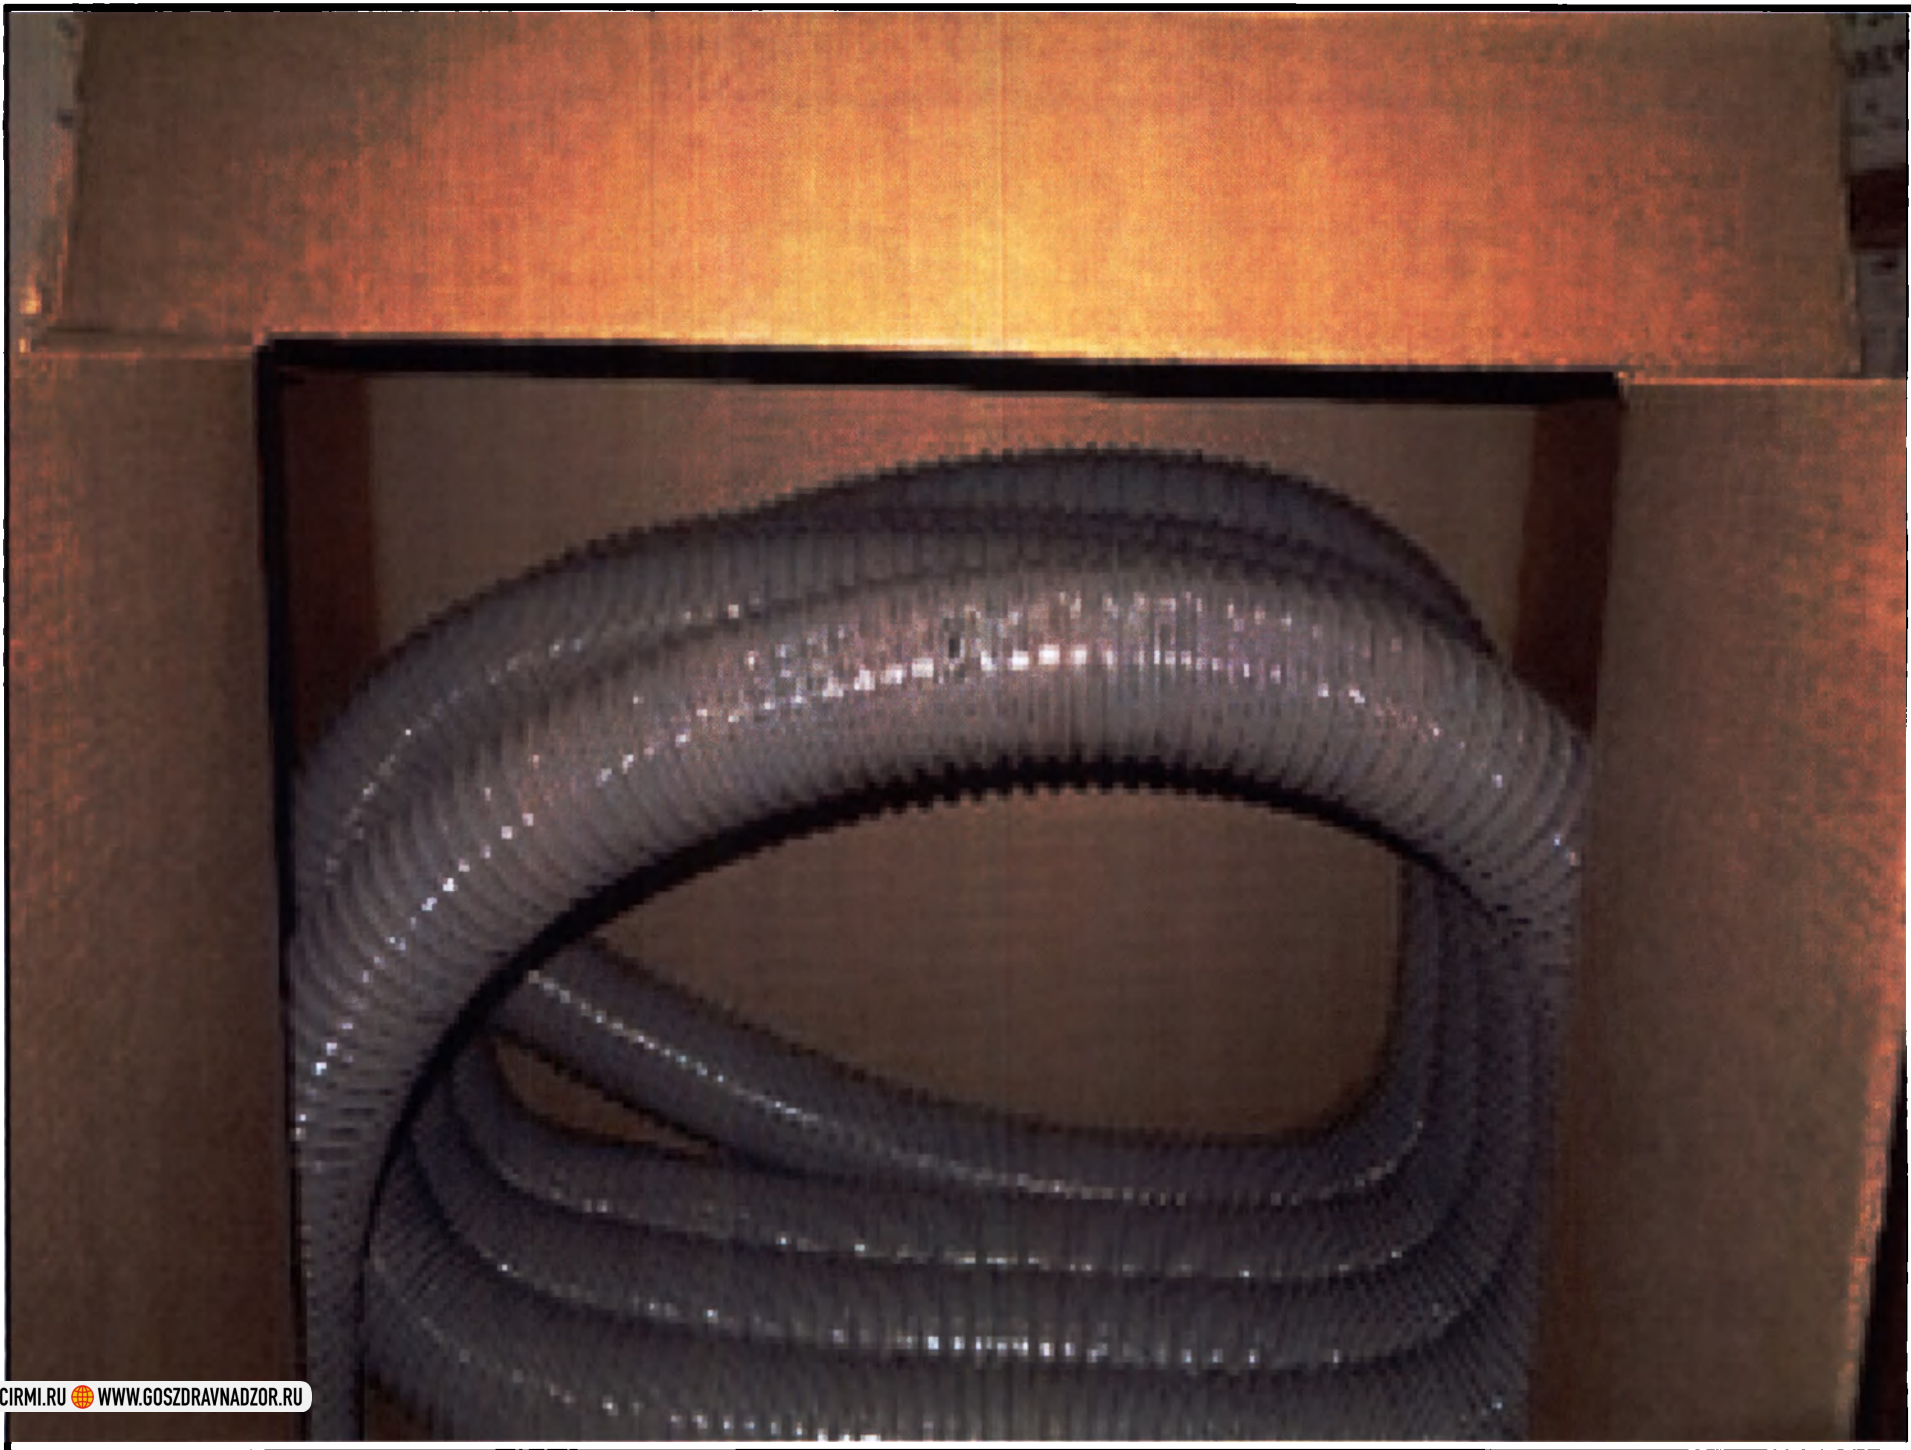


27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

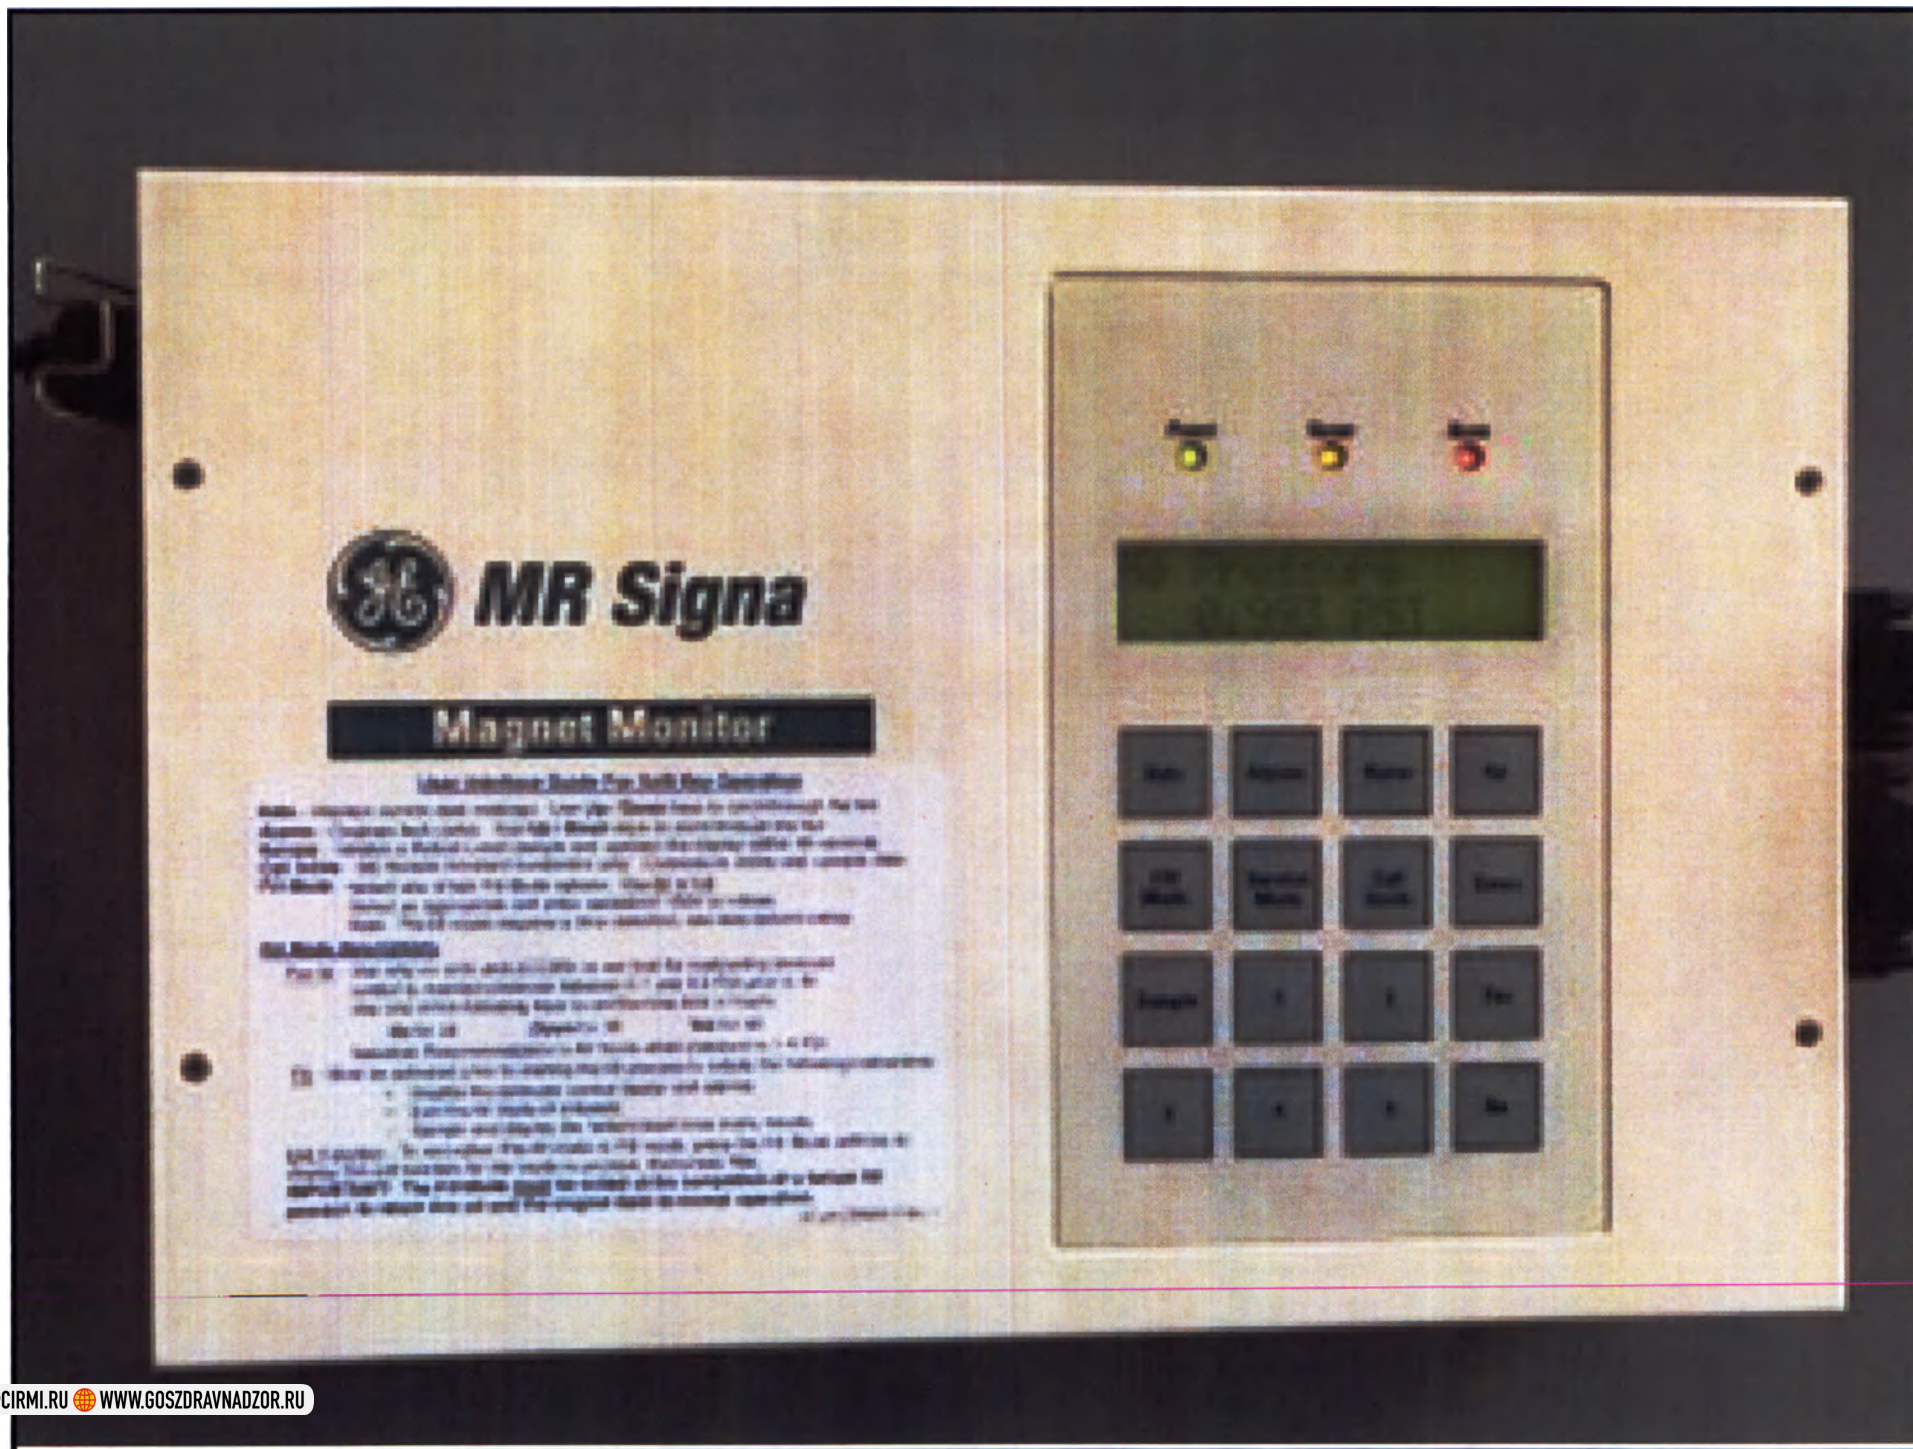


27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).




27. Блоки охлаждения МР томографа (не более 20 шт.).

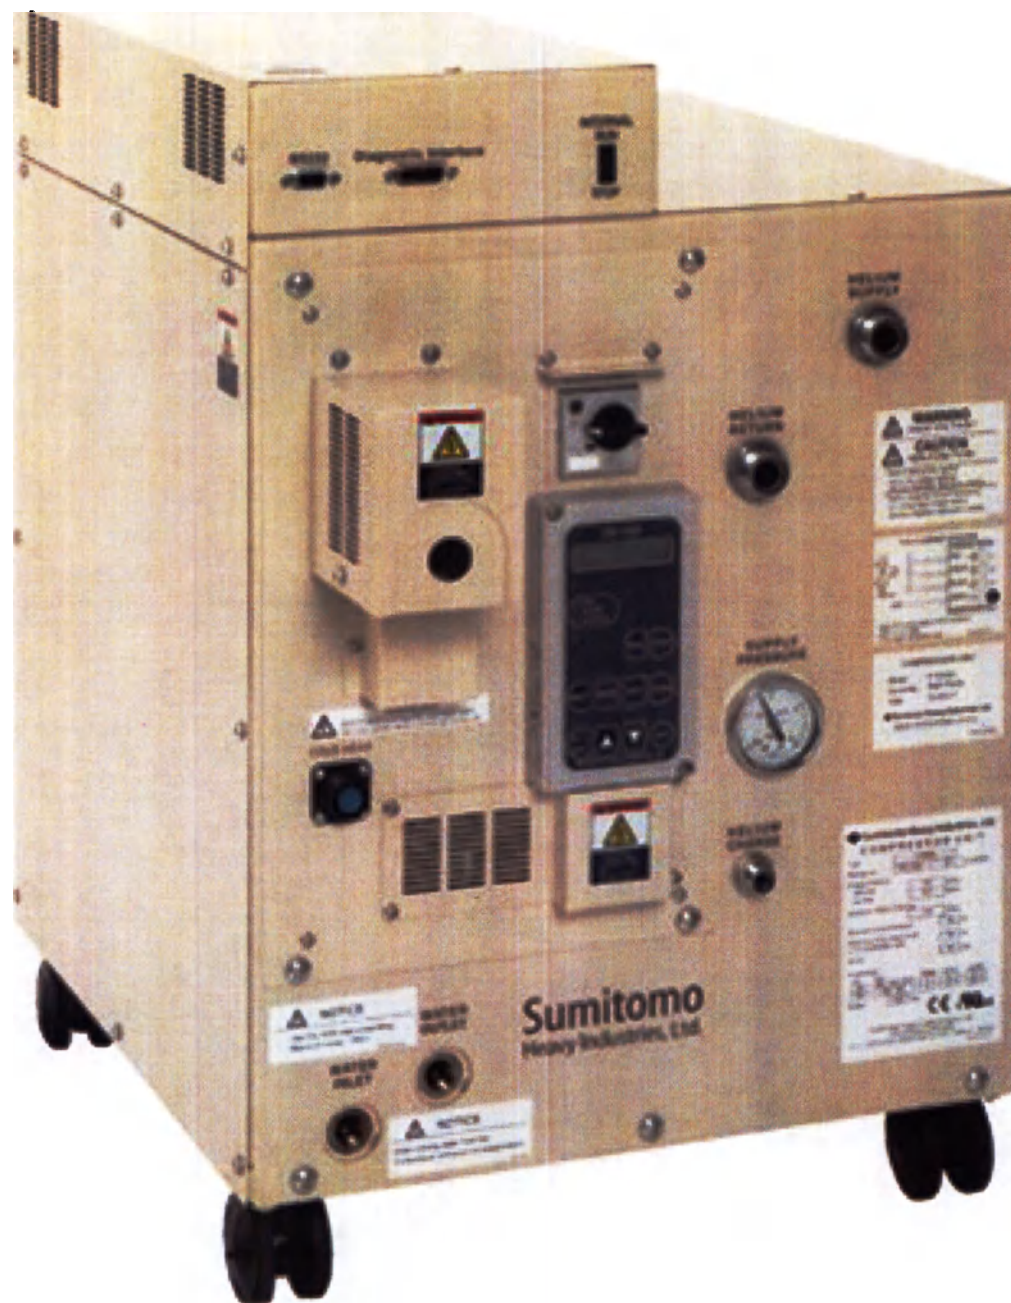

28. Виброакустические маты (не более 50 шт.).

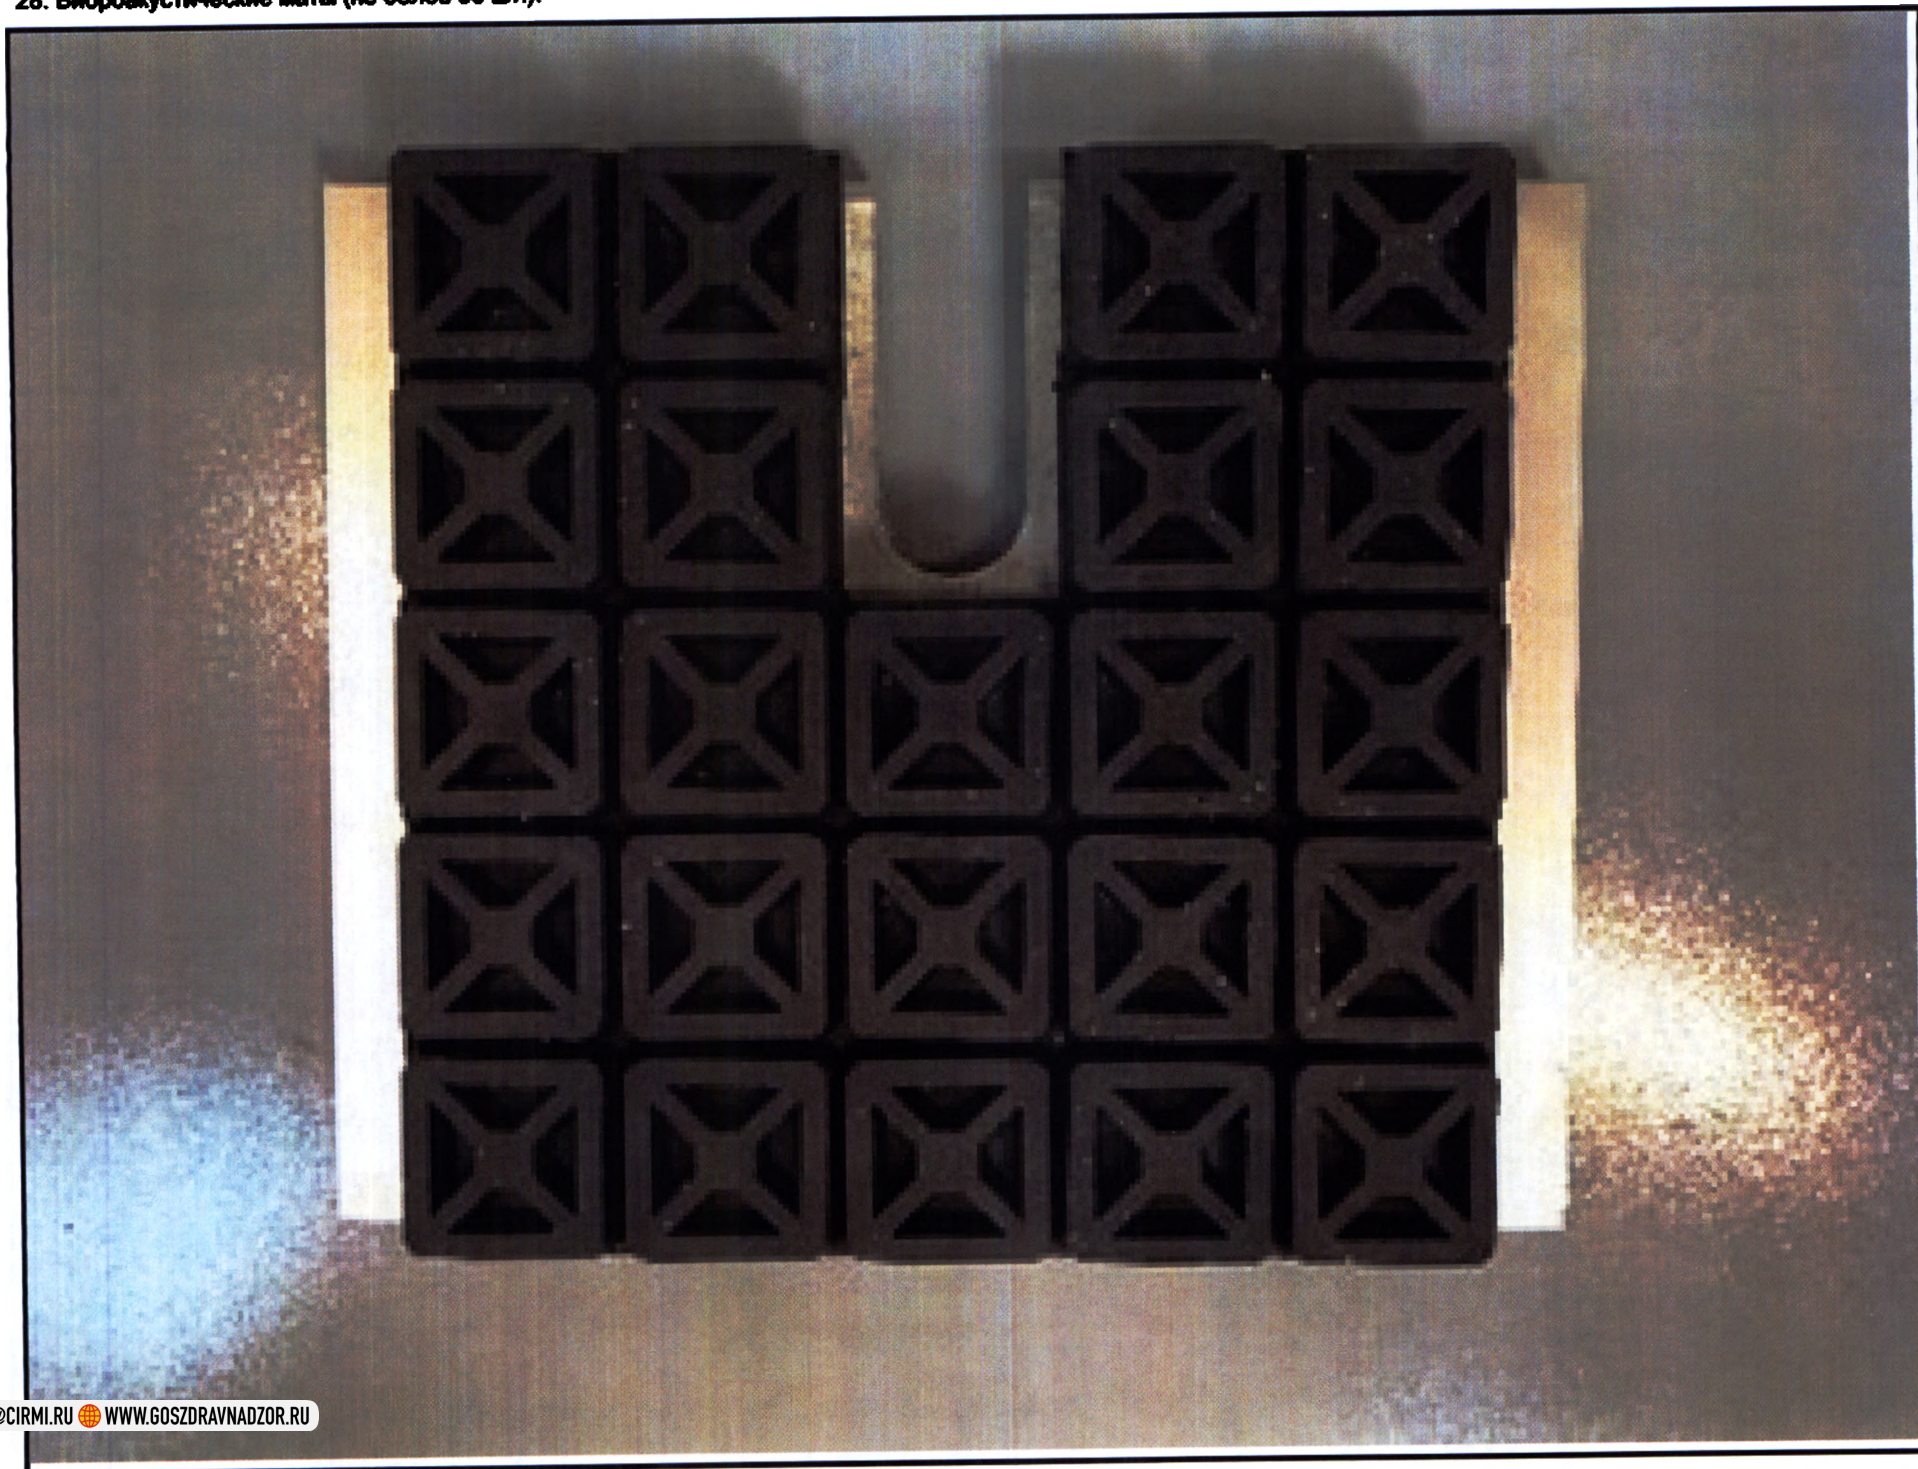

28. Виброакустические маты (не более 50 шт.).

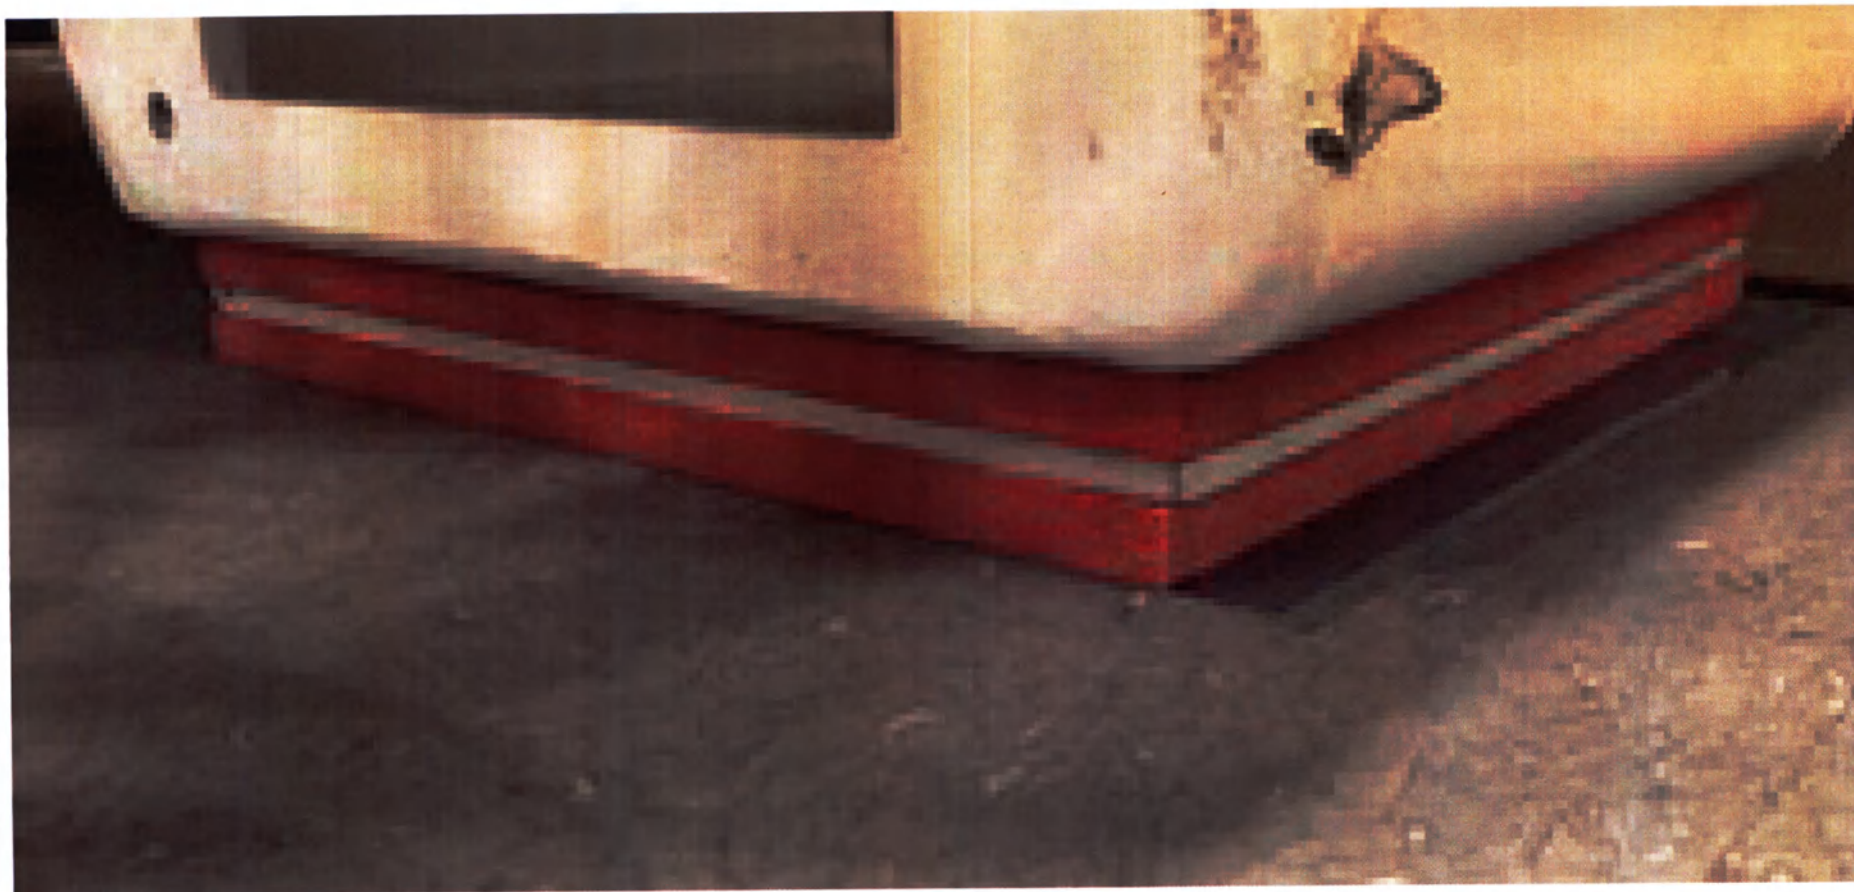


29. Каталка немагнитная облегченная с переменной высотой (не более 5 шт.).



29. Каталка немагнитная облегченная с переменной высотой (не более 5 шт.).



30. МРТ совместимое видеоустройство (не более 5 шт.).

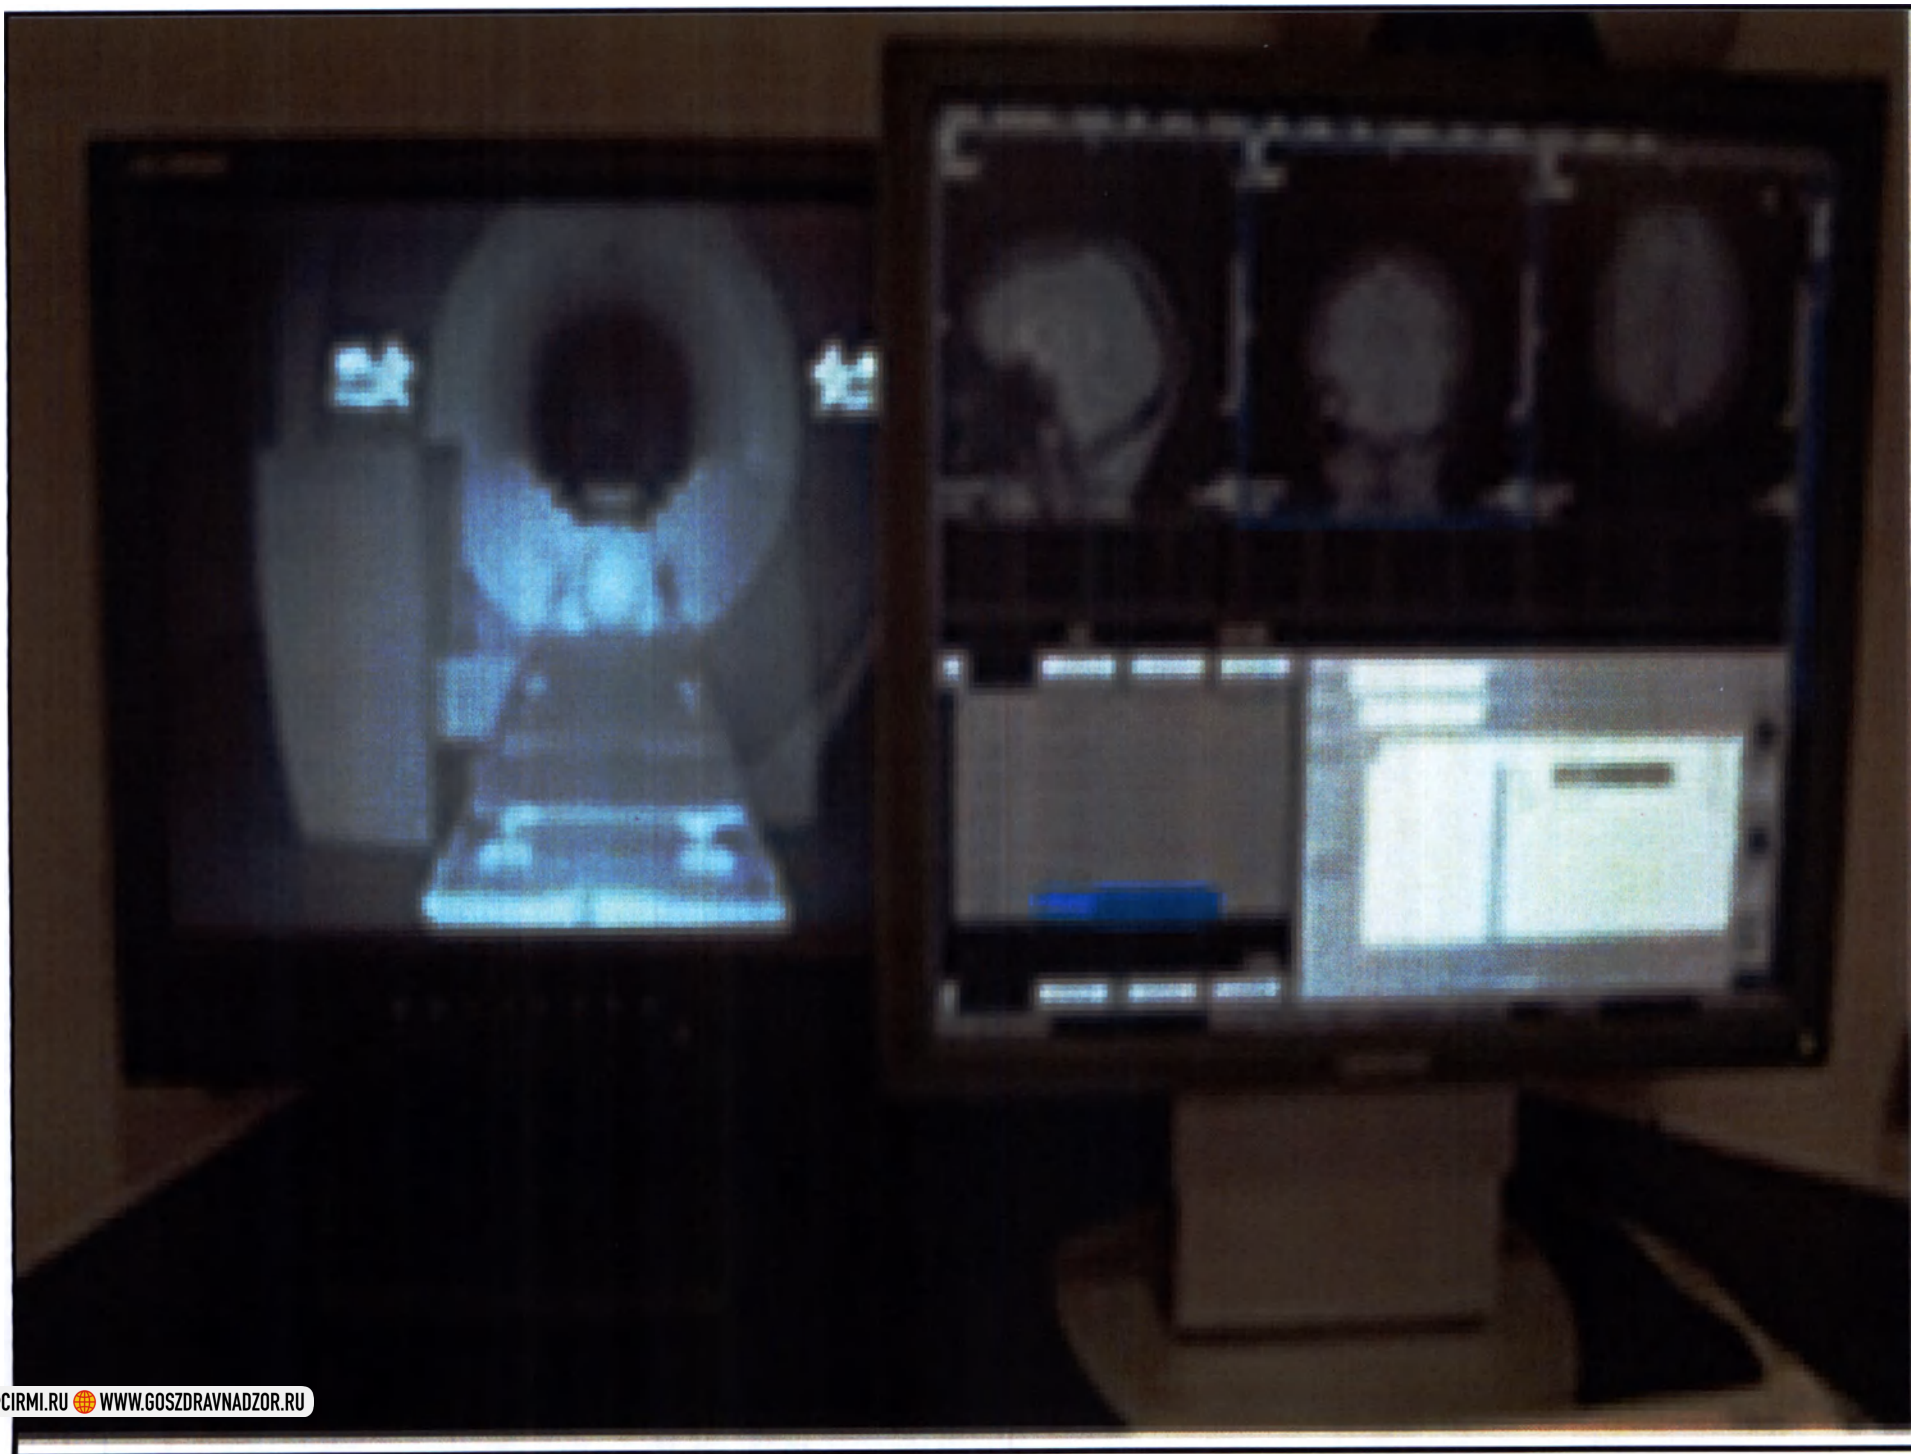

30. МРТ совместимое видеоустройство (не более 5 шт.).



30. МРТ совместимое видеоустройство (не более 5 шт.).



30. МРТ совместимое видеоустройство (не более 5 шт.).



31. МРТ совместимое аудиоустройство (не более 5 шт.).



31. МРТ совместимое аудиоустройство (не более 5 шт.).




32. Портативный металлодетектор.




33. Комплект предупредительных обозначений.





33. Комплект предупредительных обозначений.

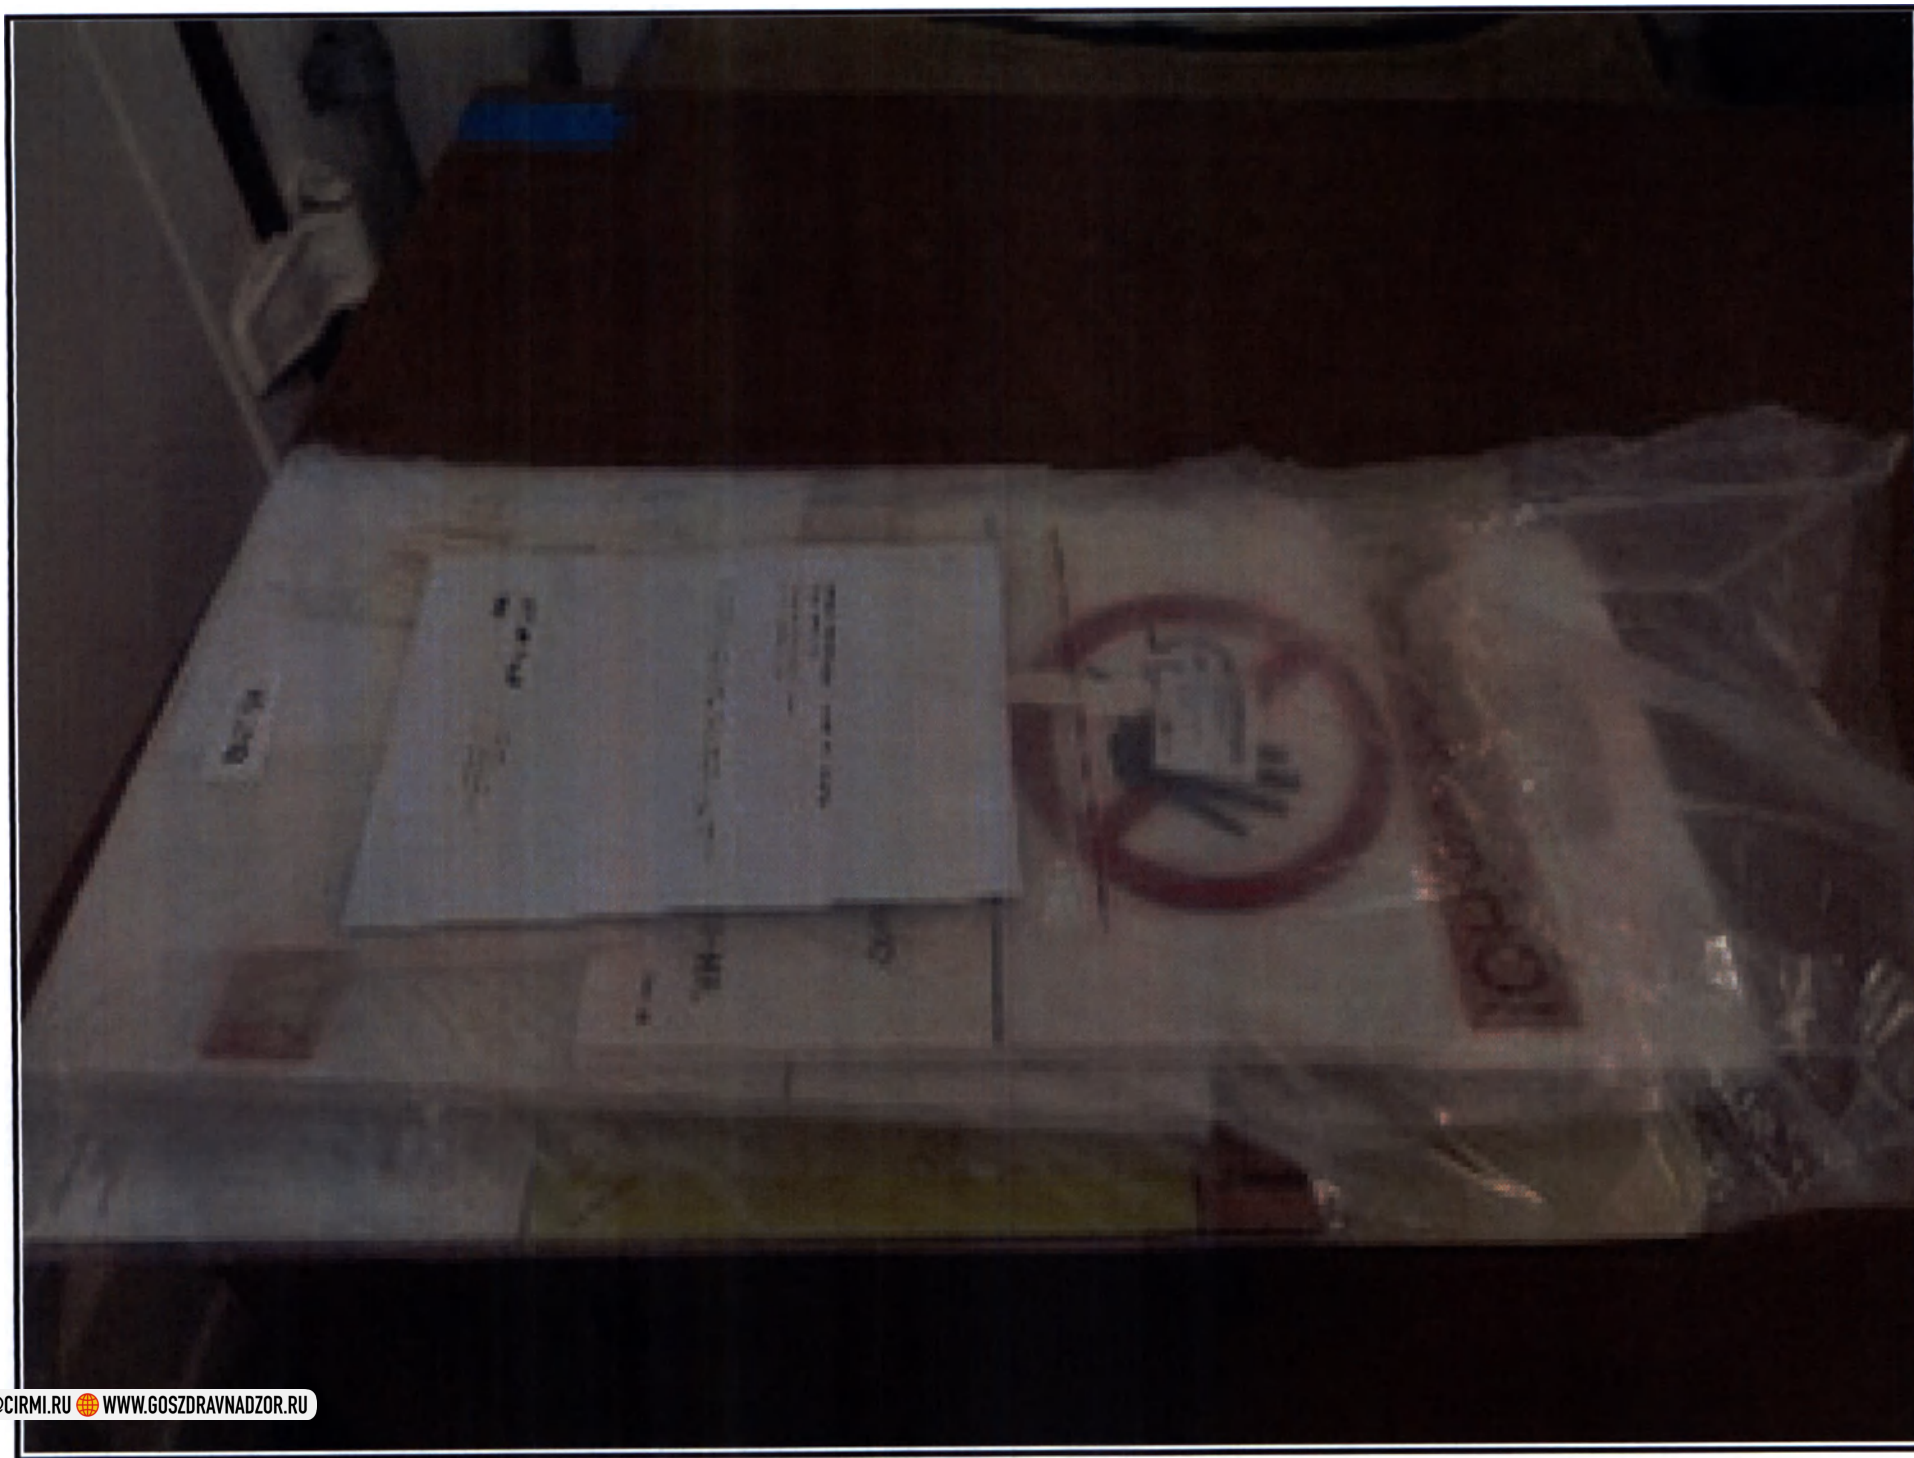

34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).

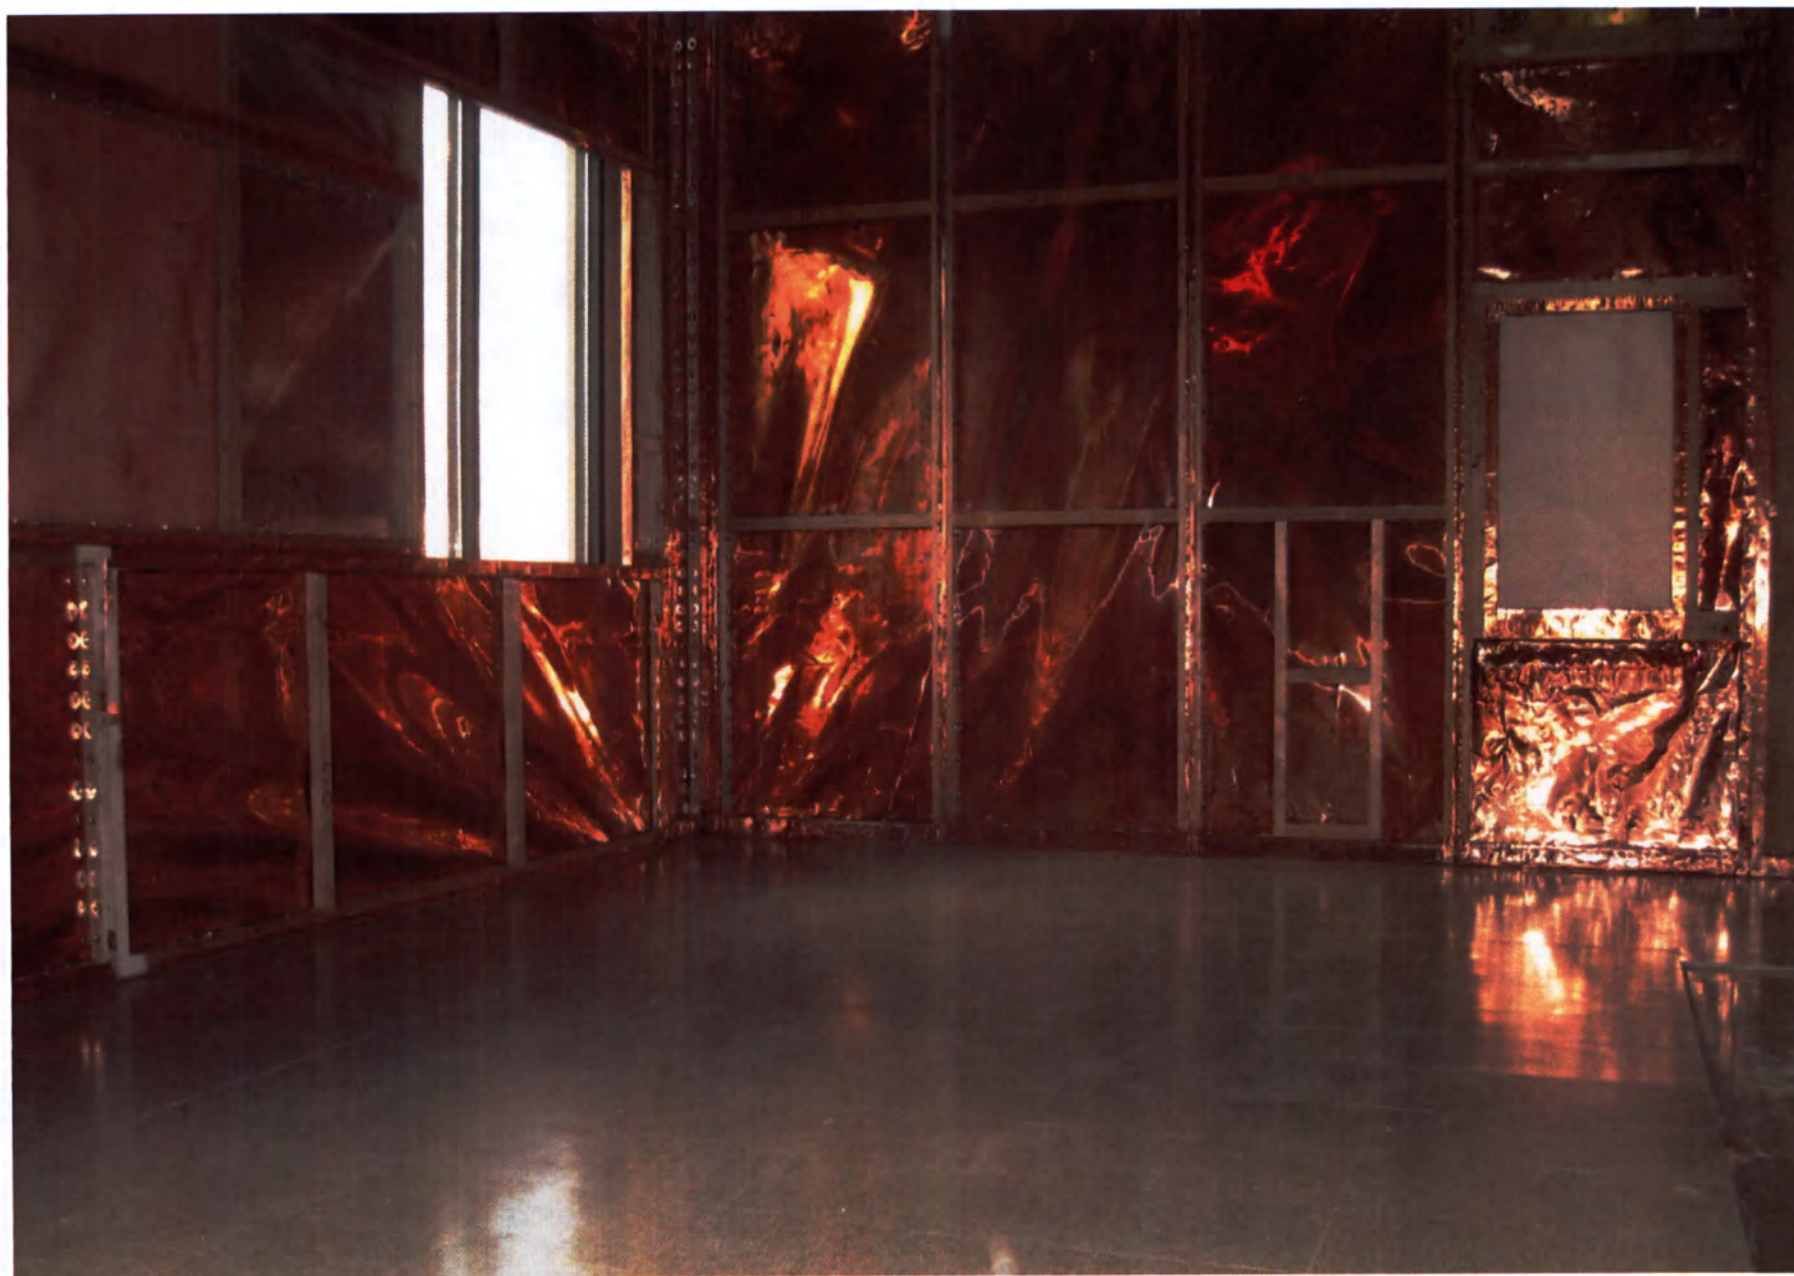

34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).

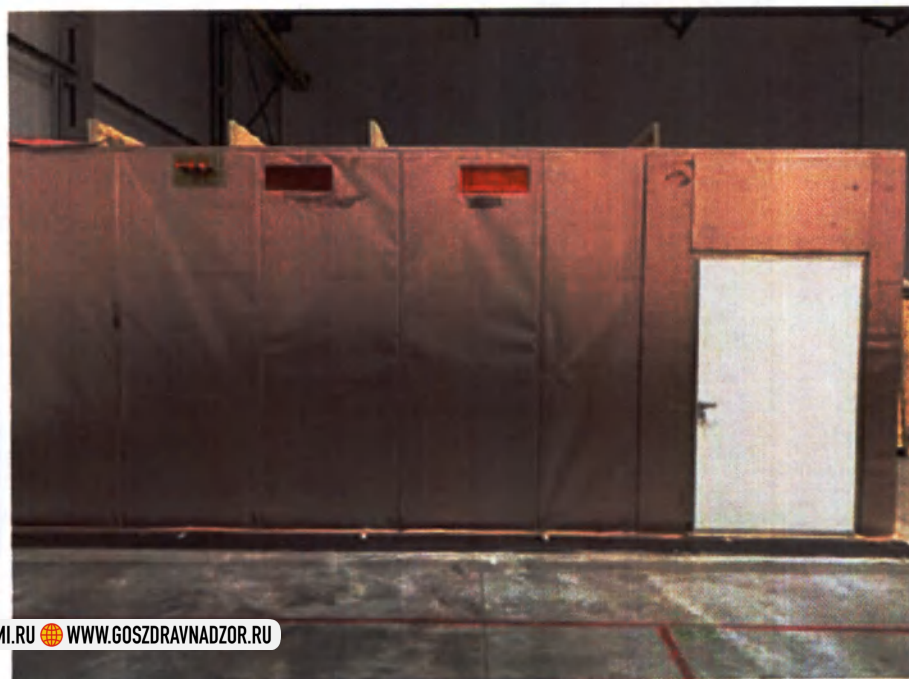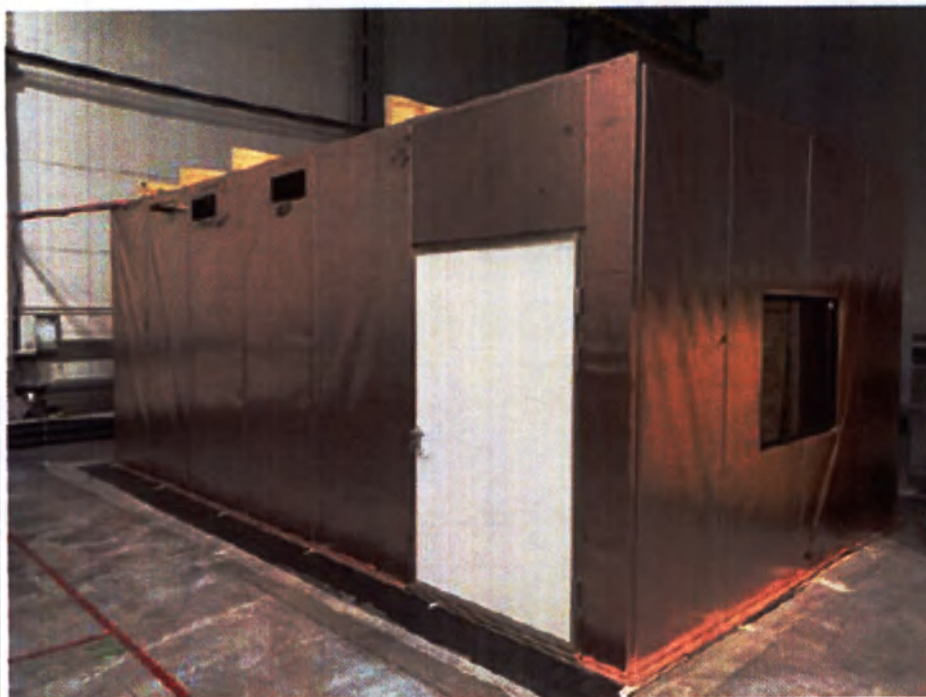

34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



34. Устройство для защитного экранирования помещения (Клетка Фарадея).



35. Контейнер для транспортировки магнита.



35. Контейнер для транспортировки магнита.



36. Немалитный шкаф для хранения катушек.




37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).



37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).




37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

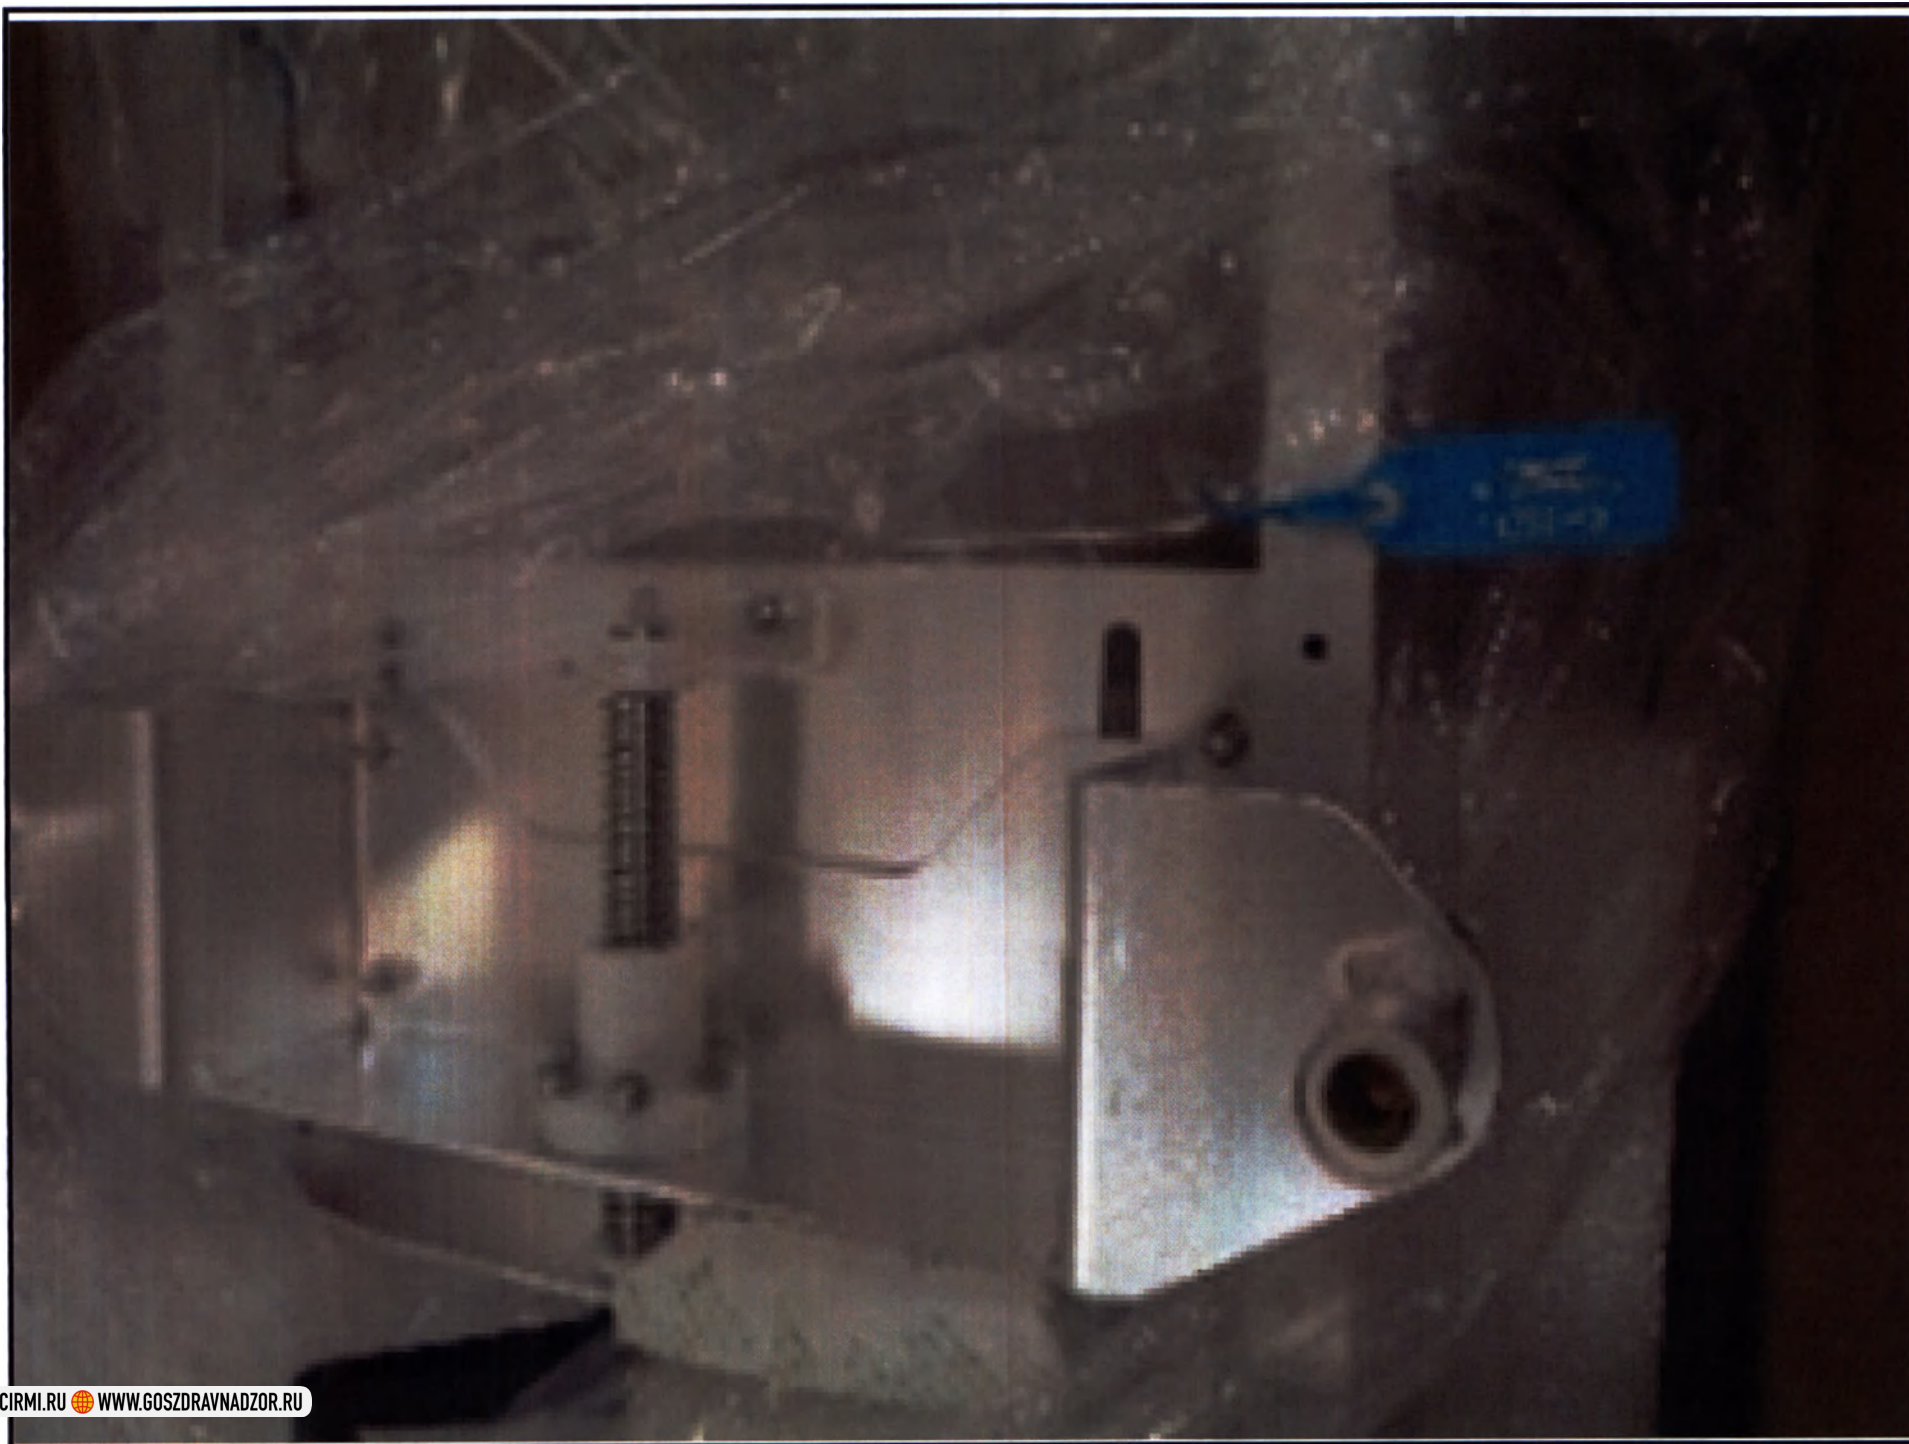


37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).



37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

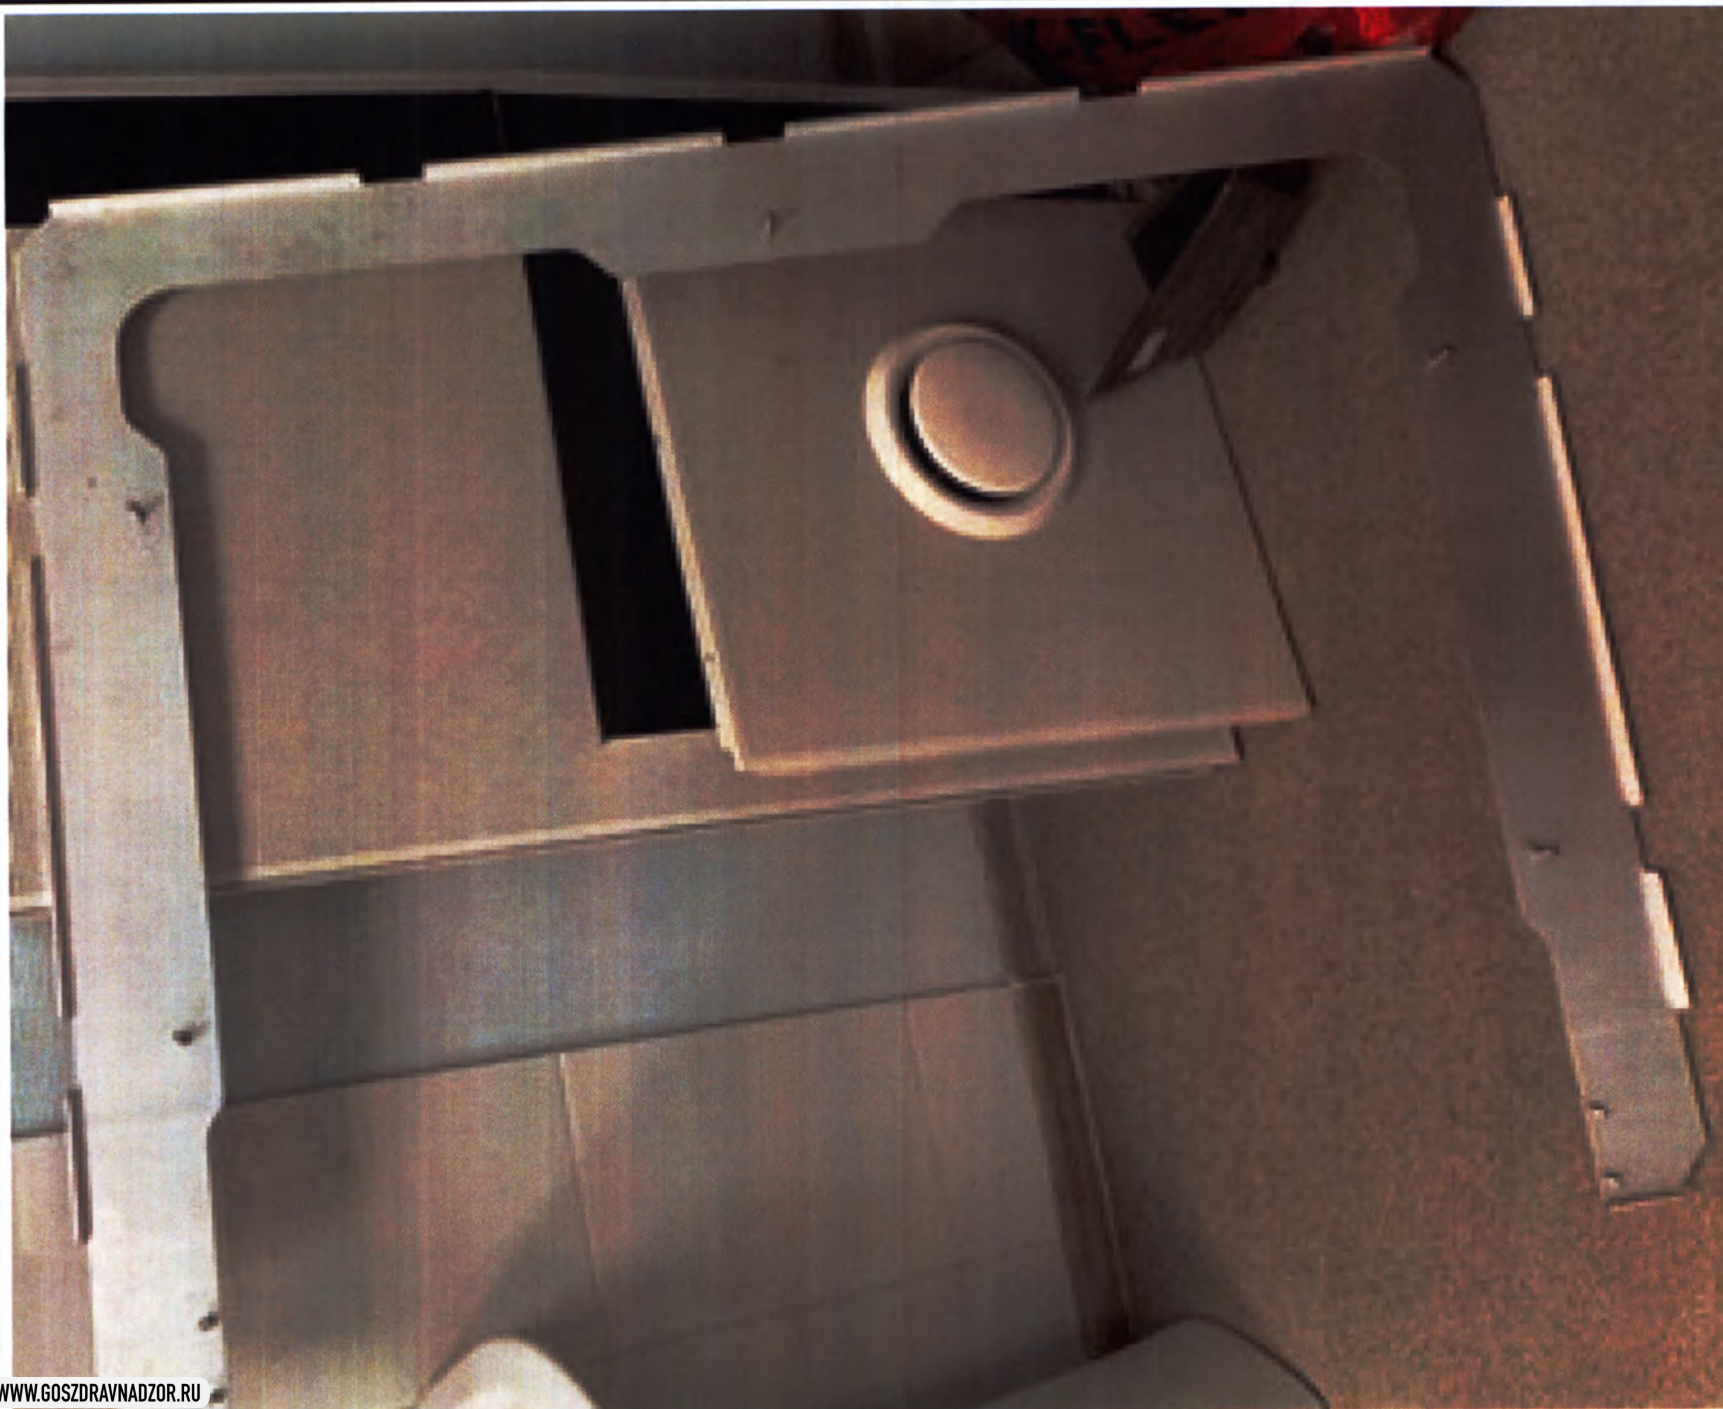

37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

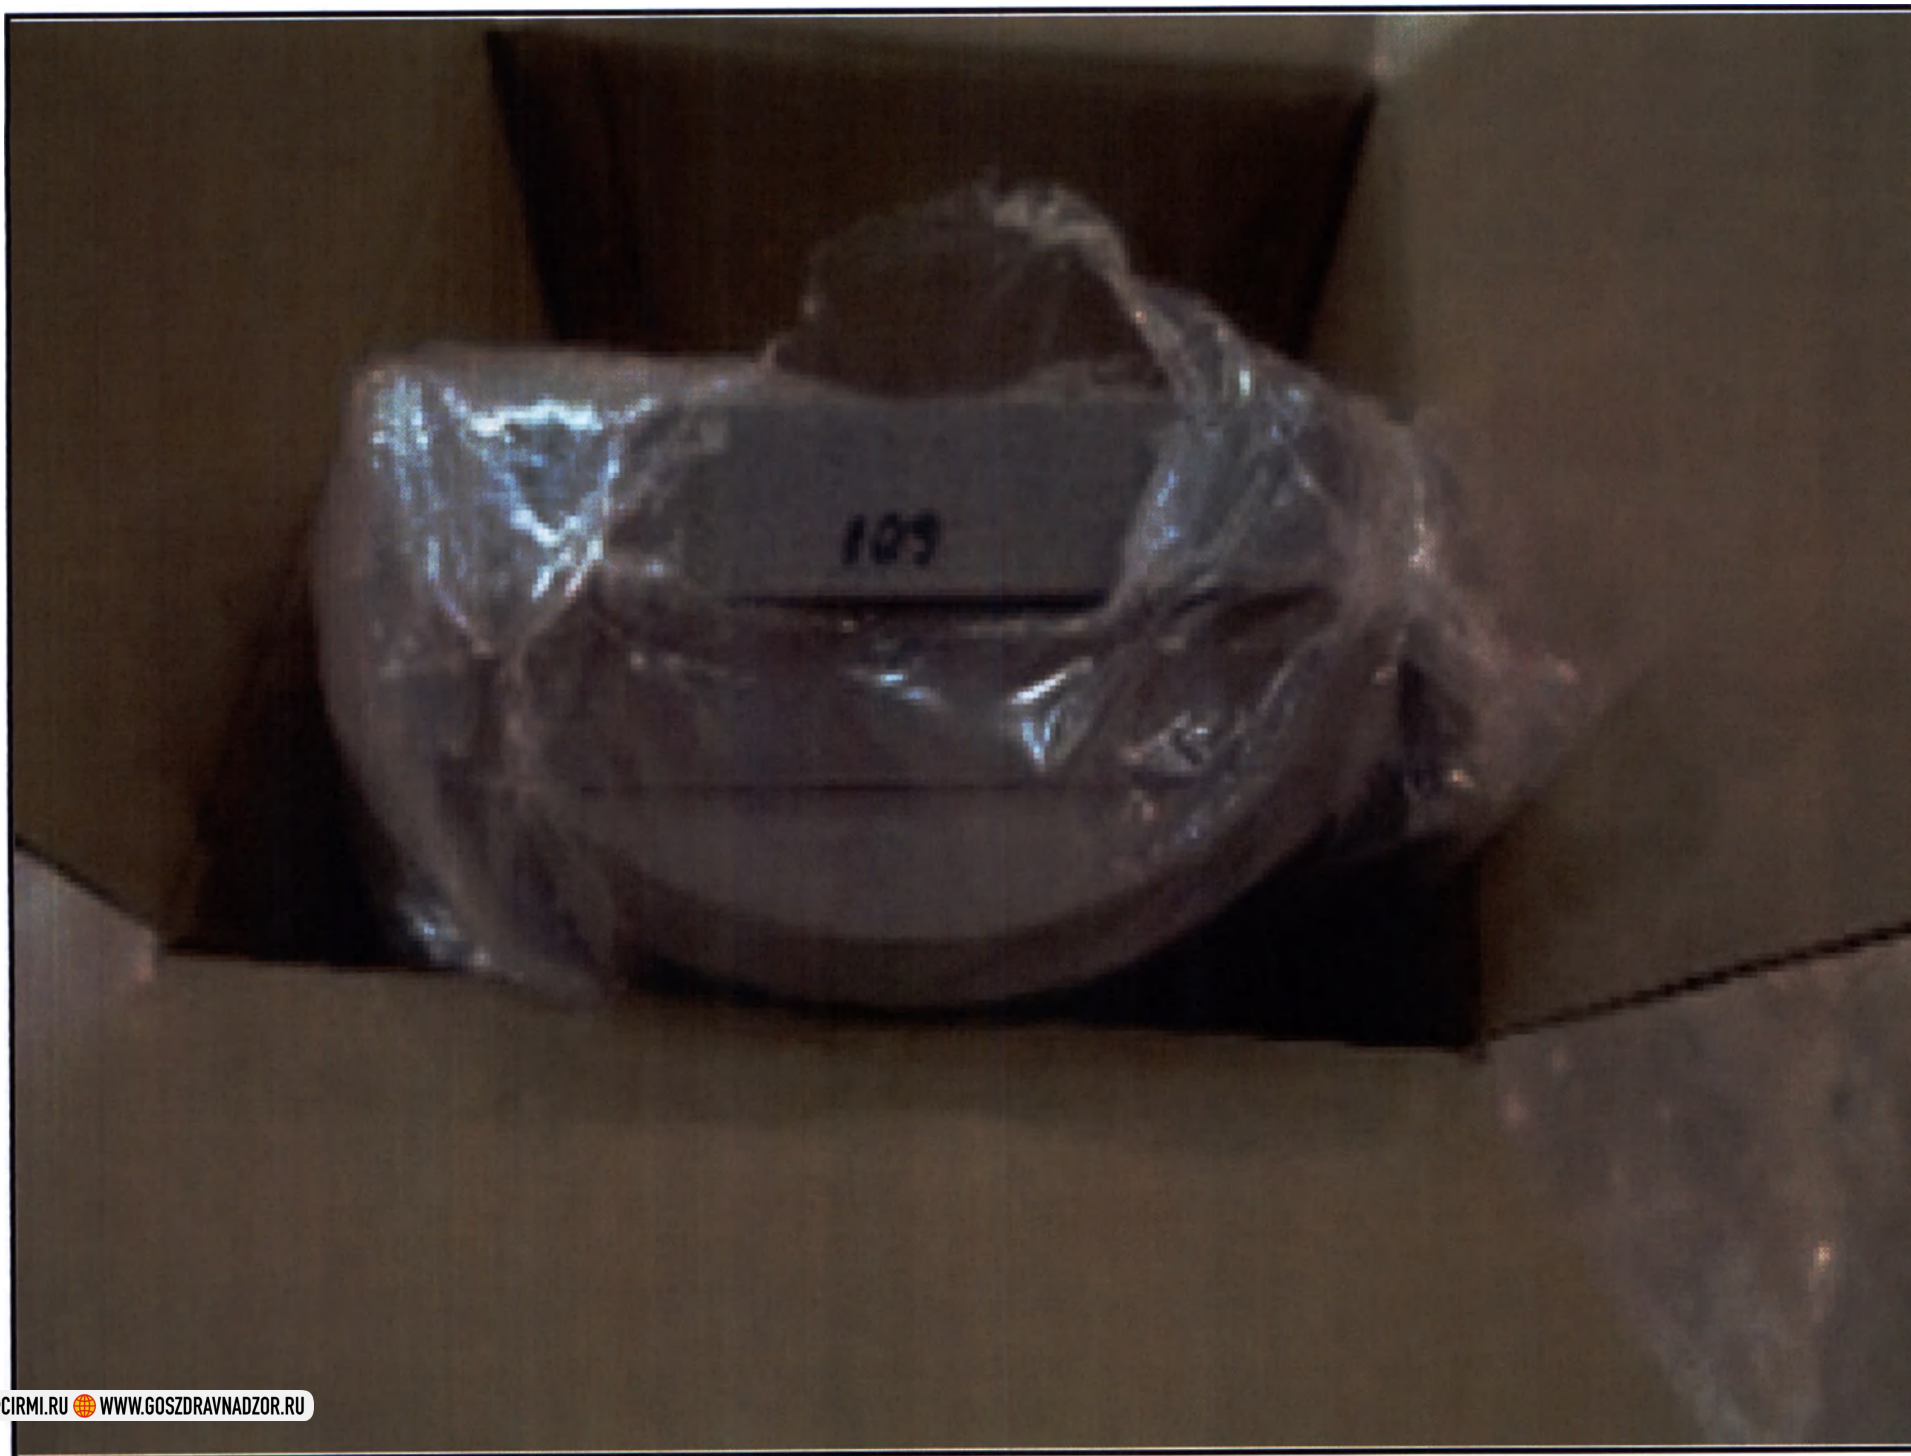

37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).




37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).



37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).




37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

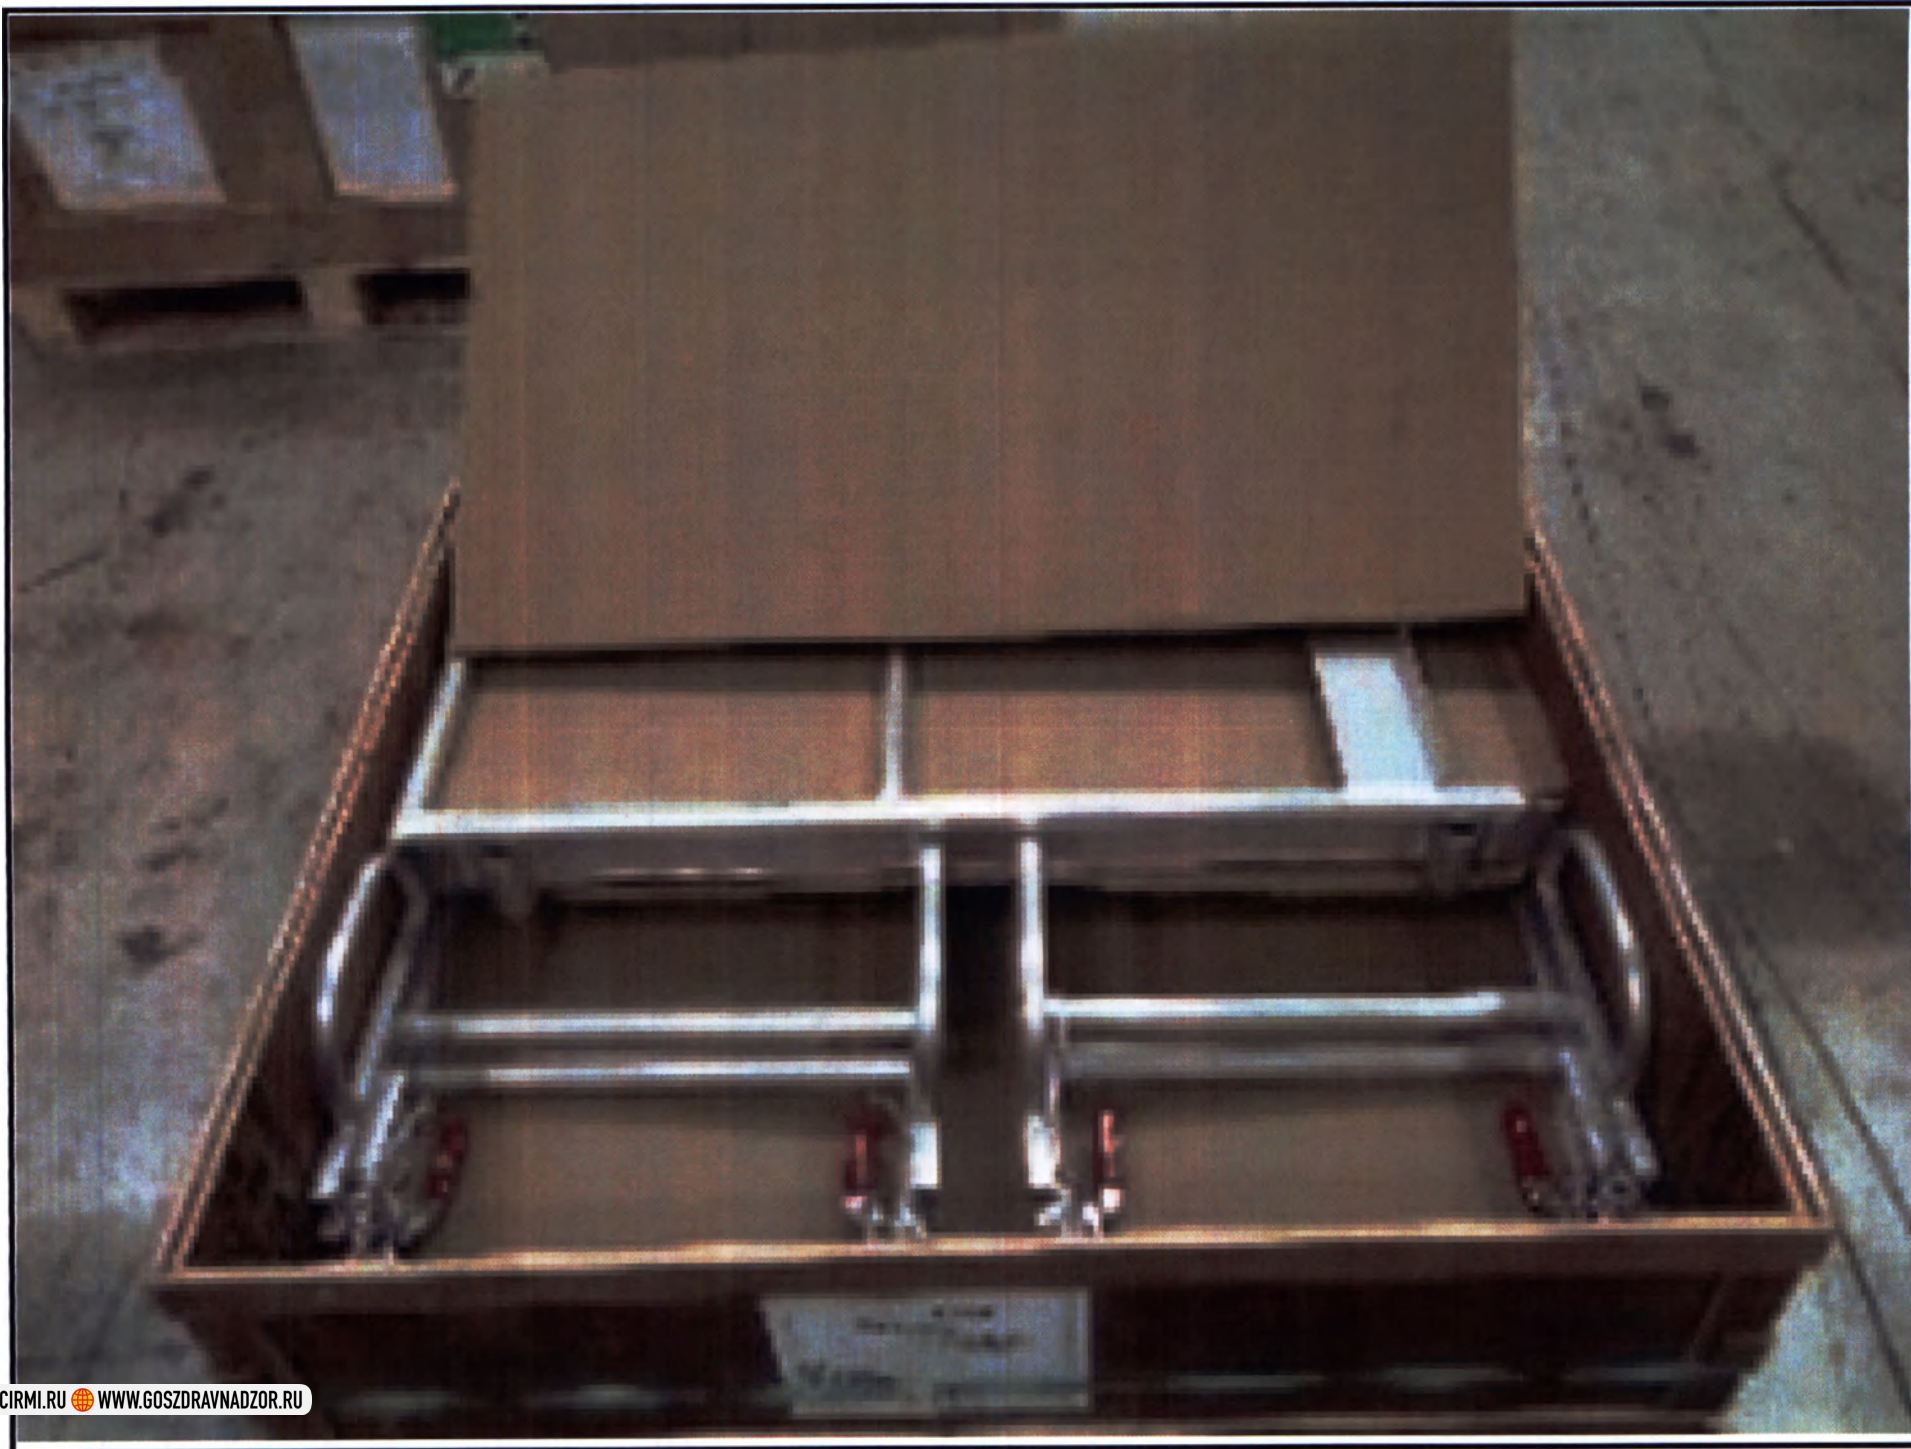


37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).



37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

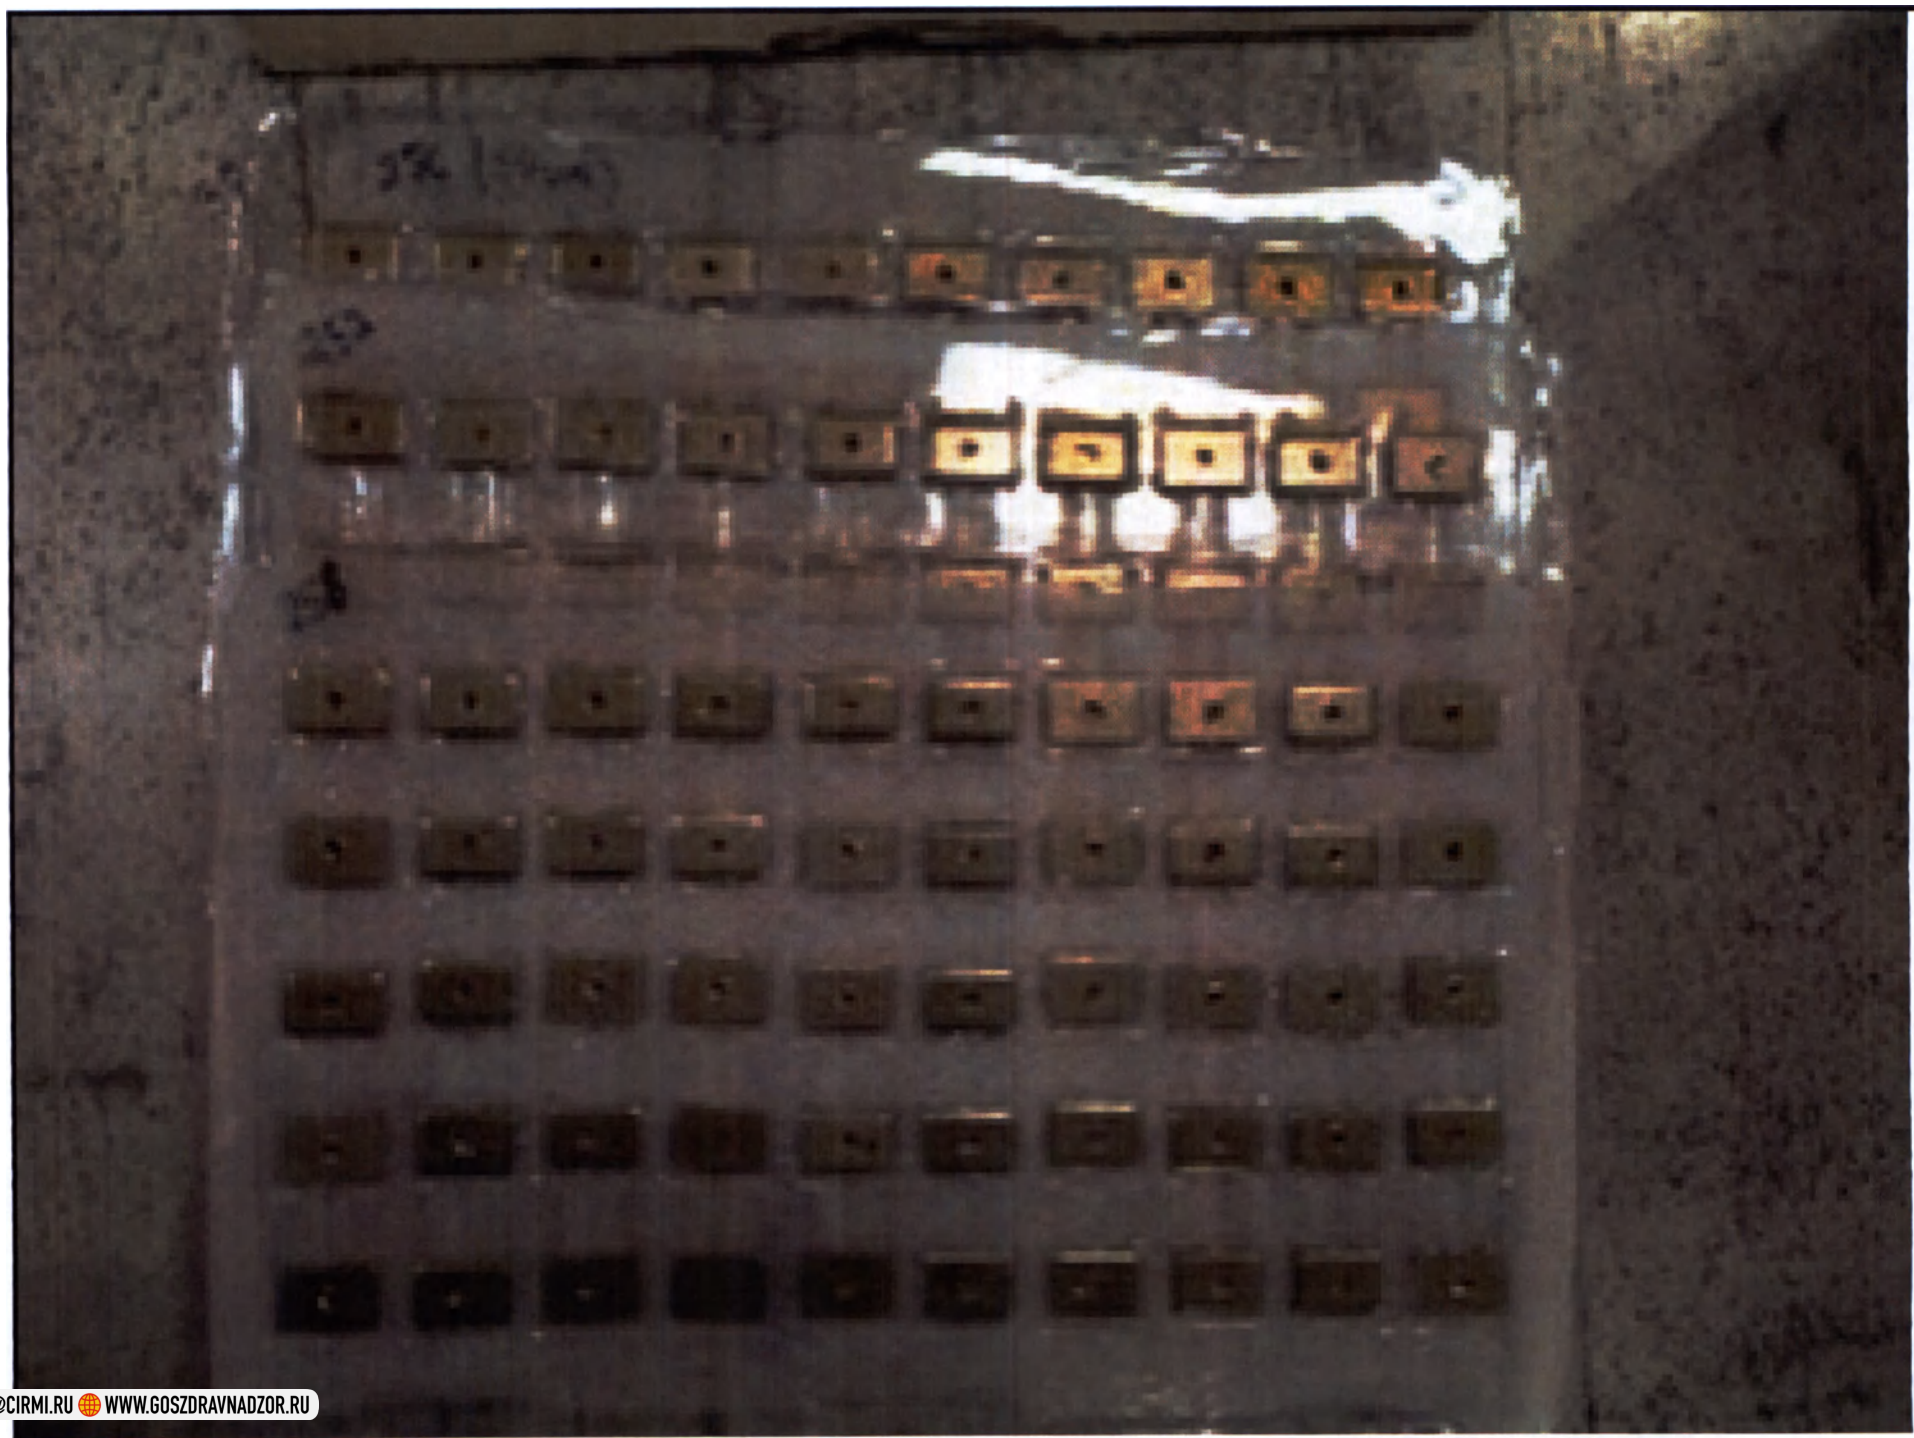

37. Сервисные и монтажные инструменты (не более 50 шт.).

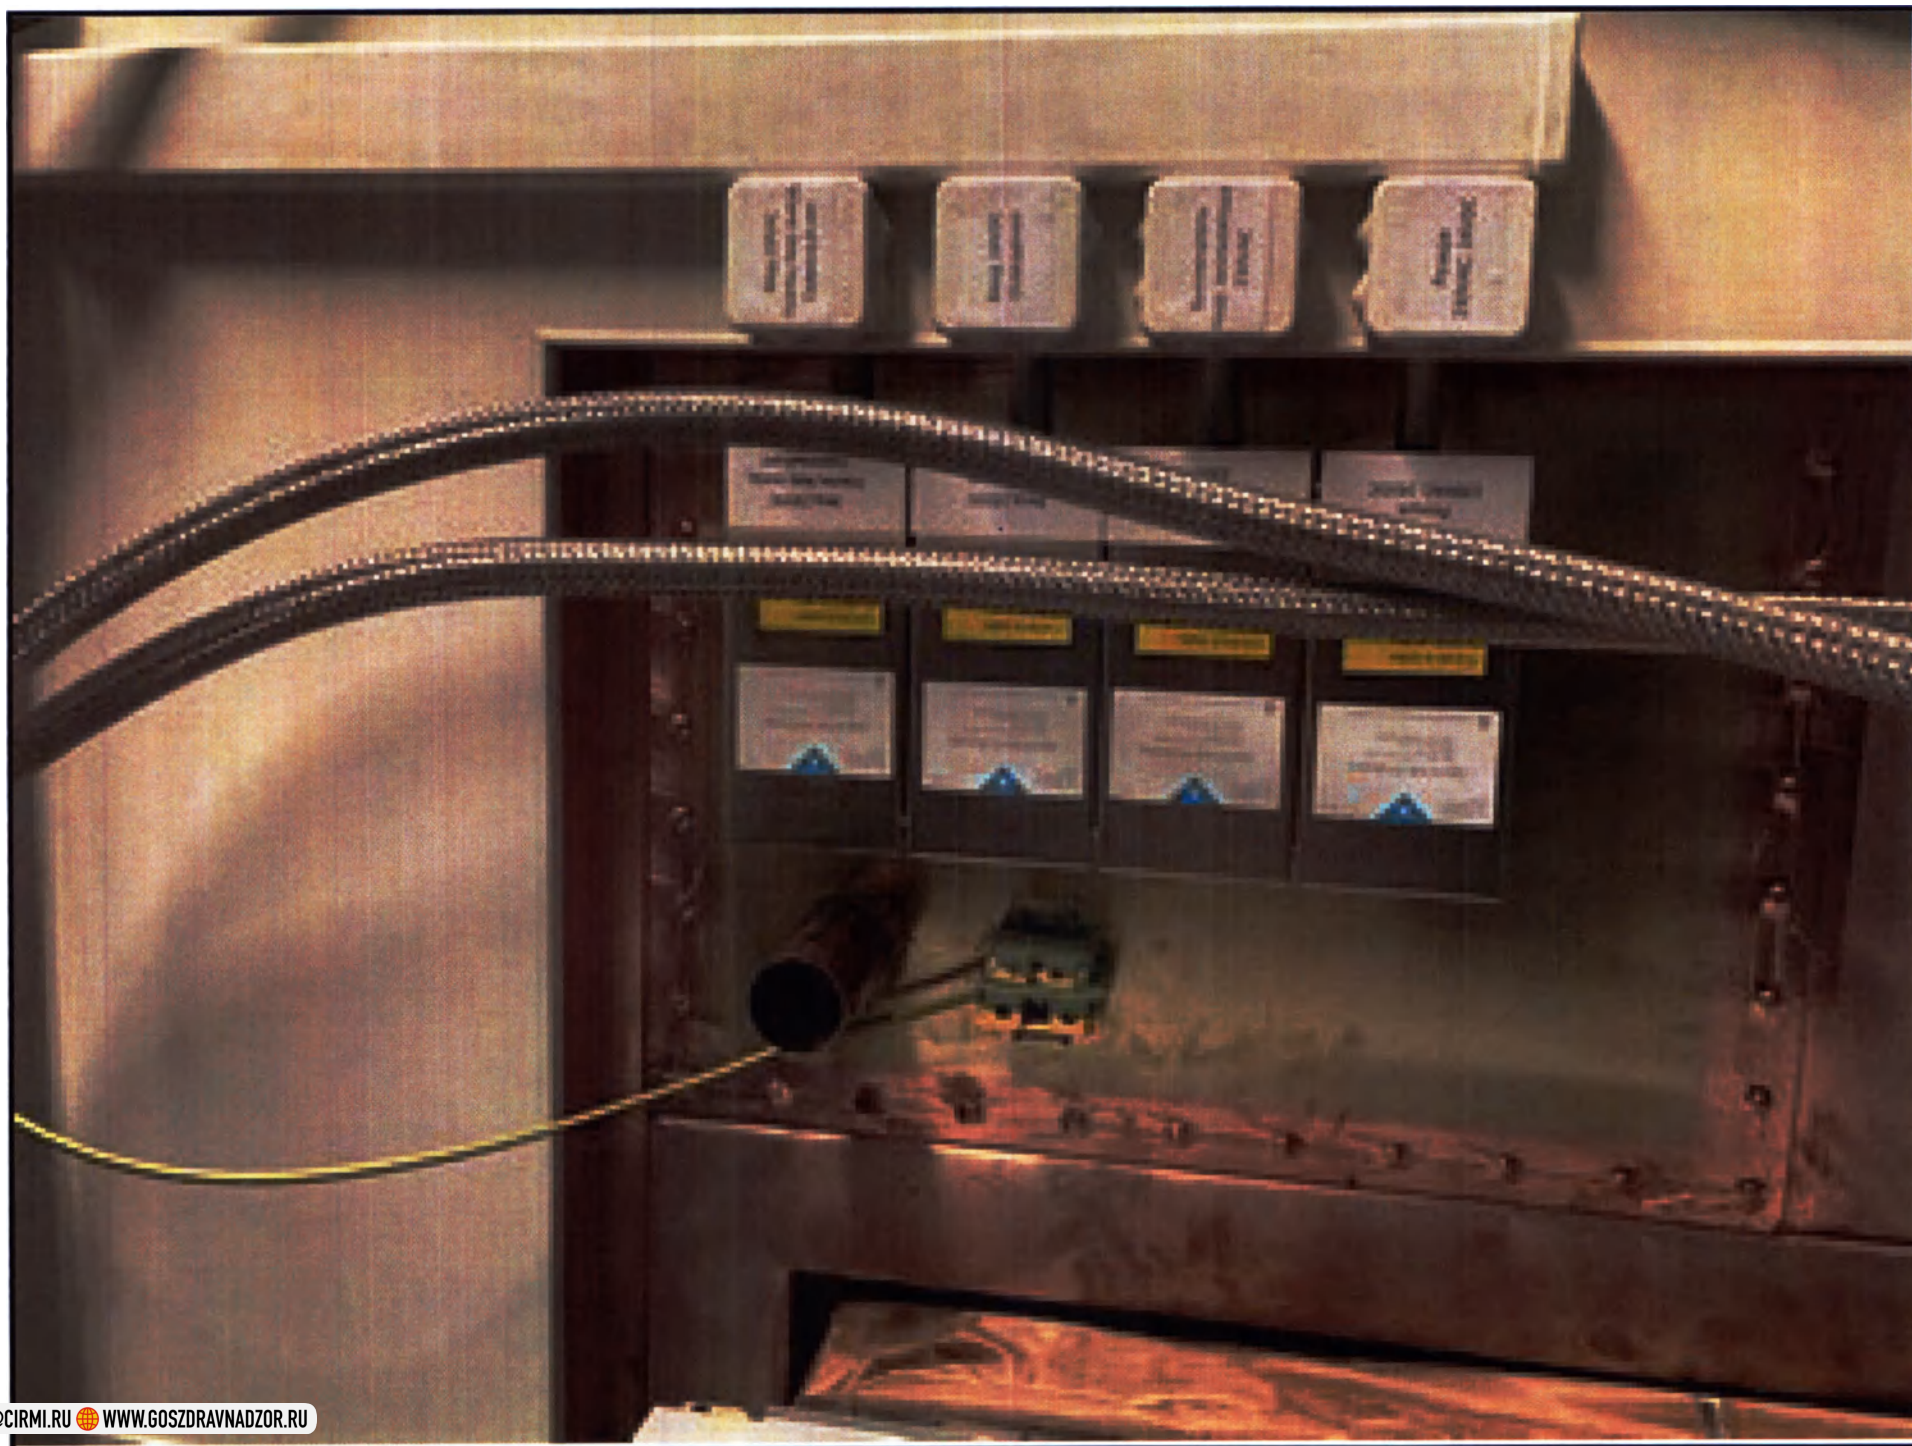


38. Тележки специальные для хранения фантомов (не более 5 шт.).




39. Специальная компьютерная рабочая станция для создания парадигм для функциональной МРТ.




40. Устройство визуализации при проведении функциональной МРТ.

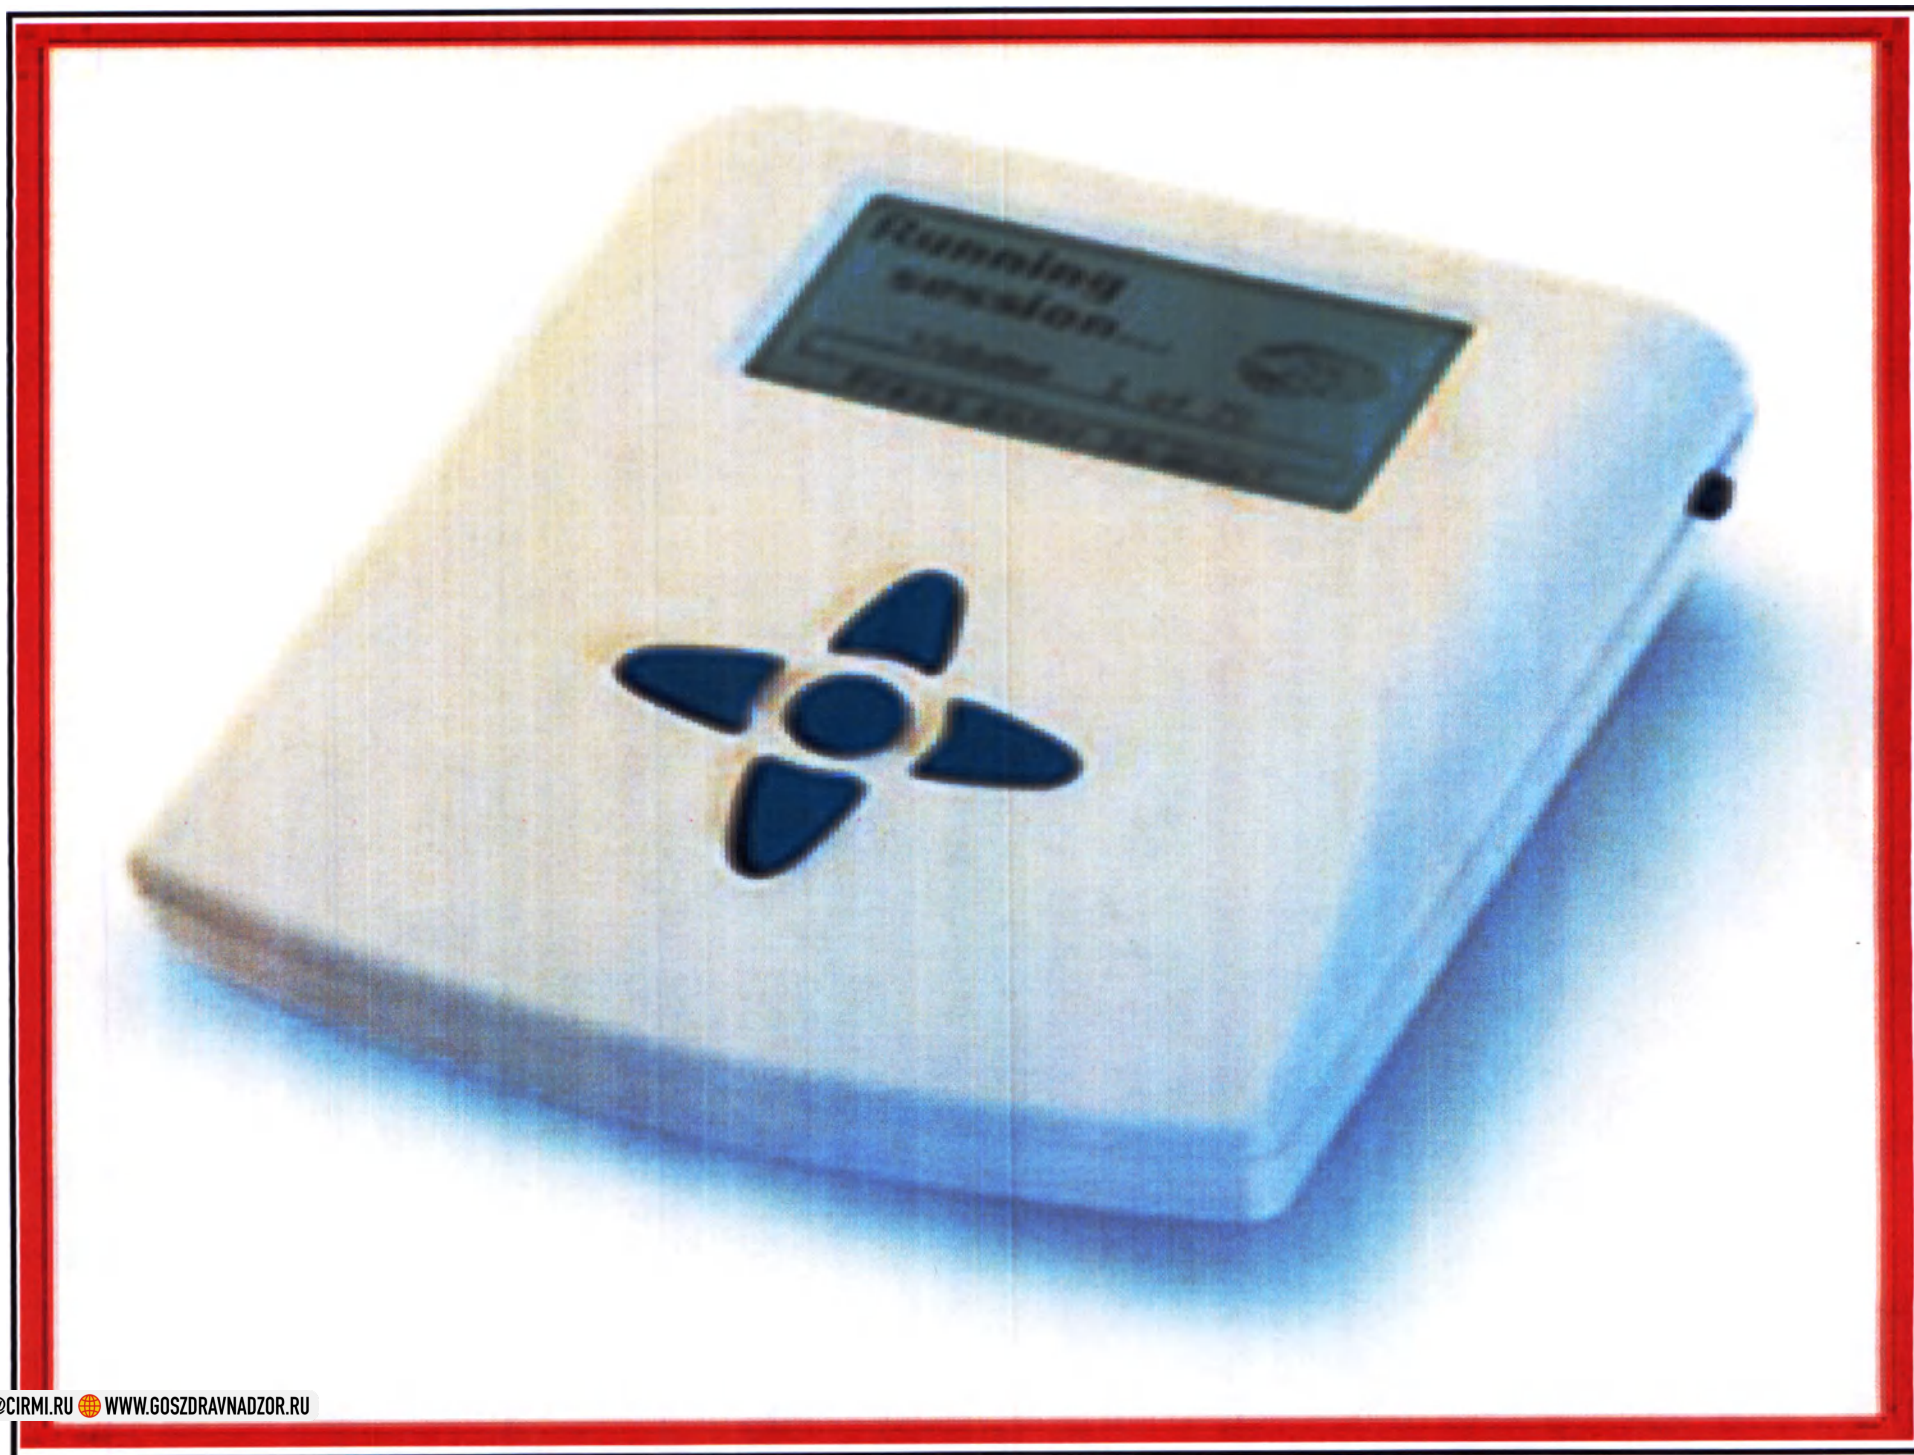

40. Устройство визуализации при проведении функциональной МРТ.

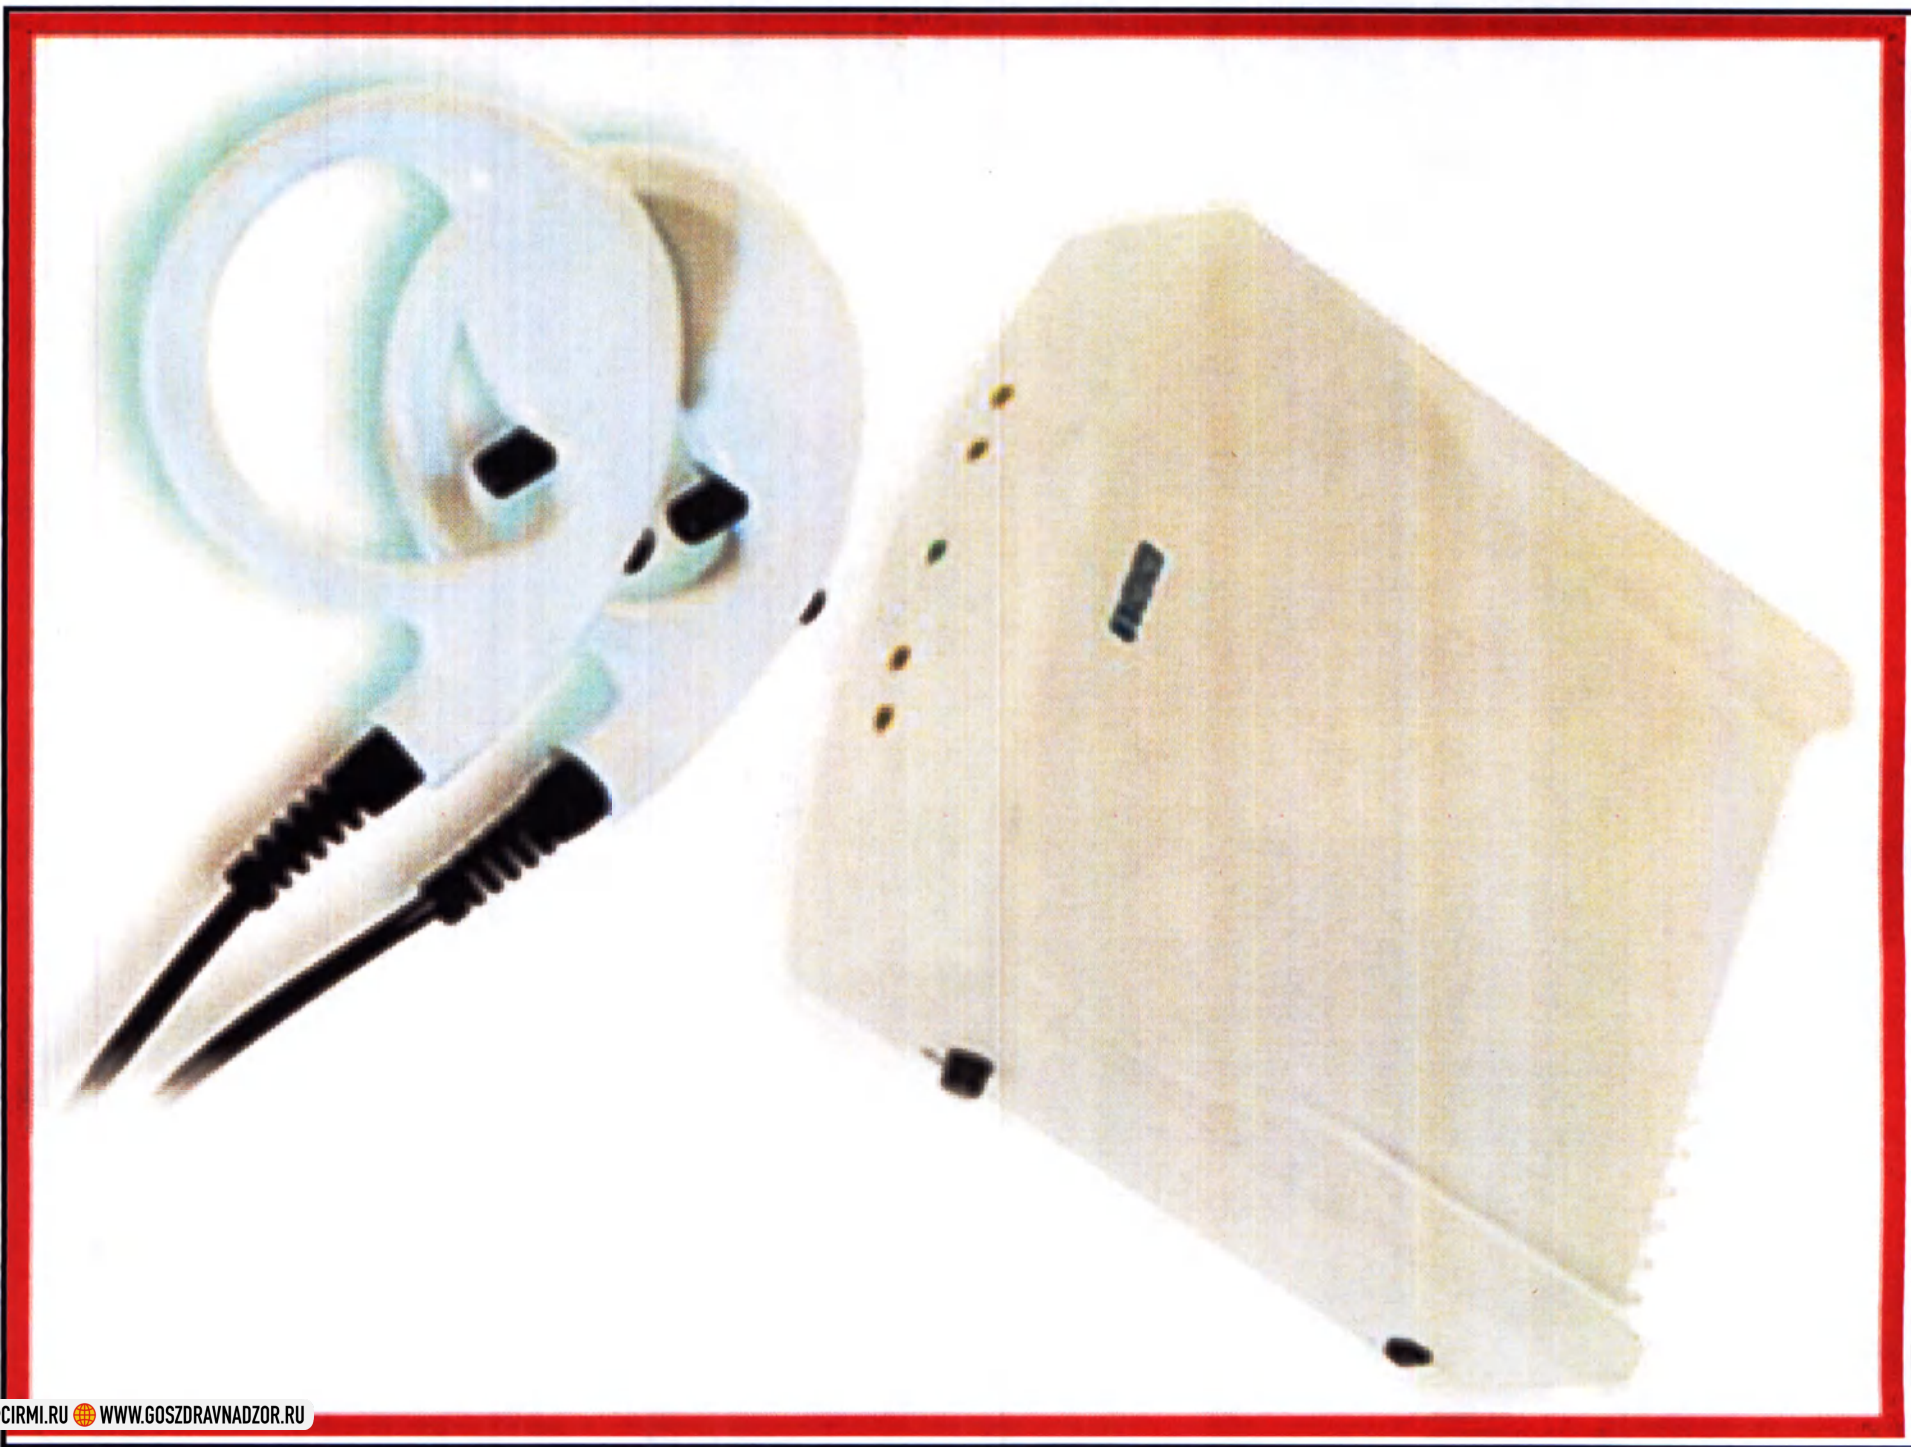

41. Панель обратной связи для проведения функциональной МРТ.

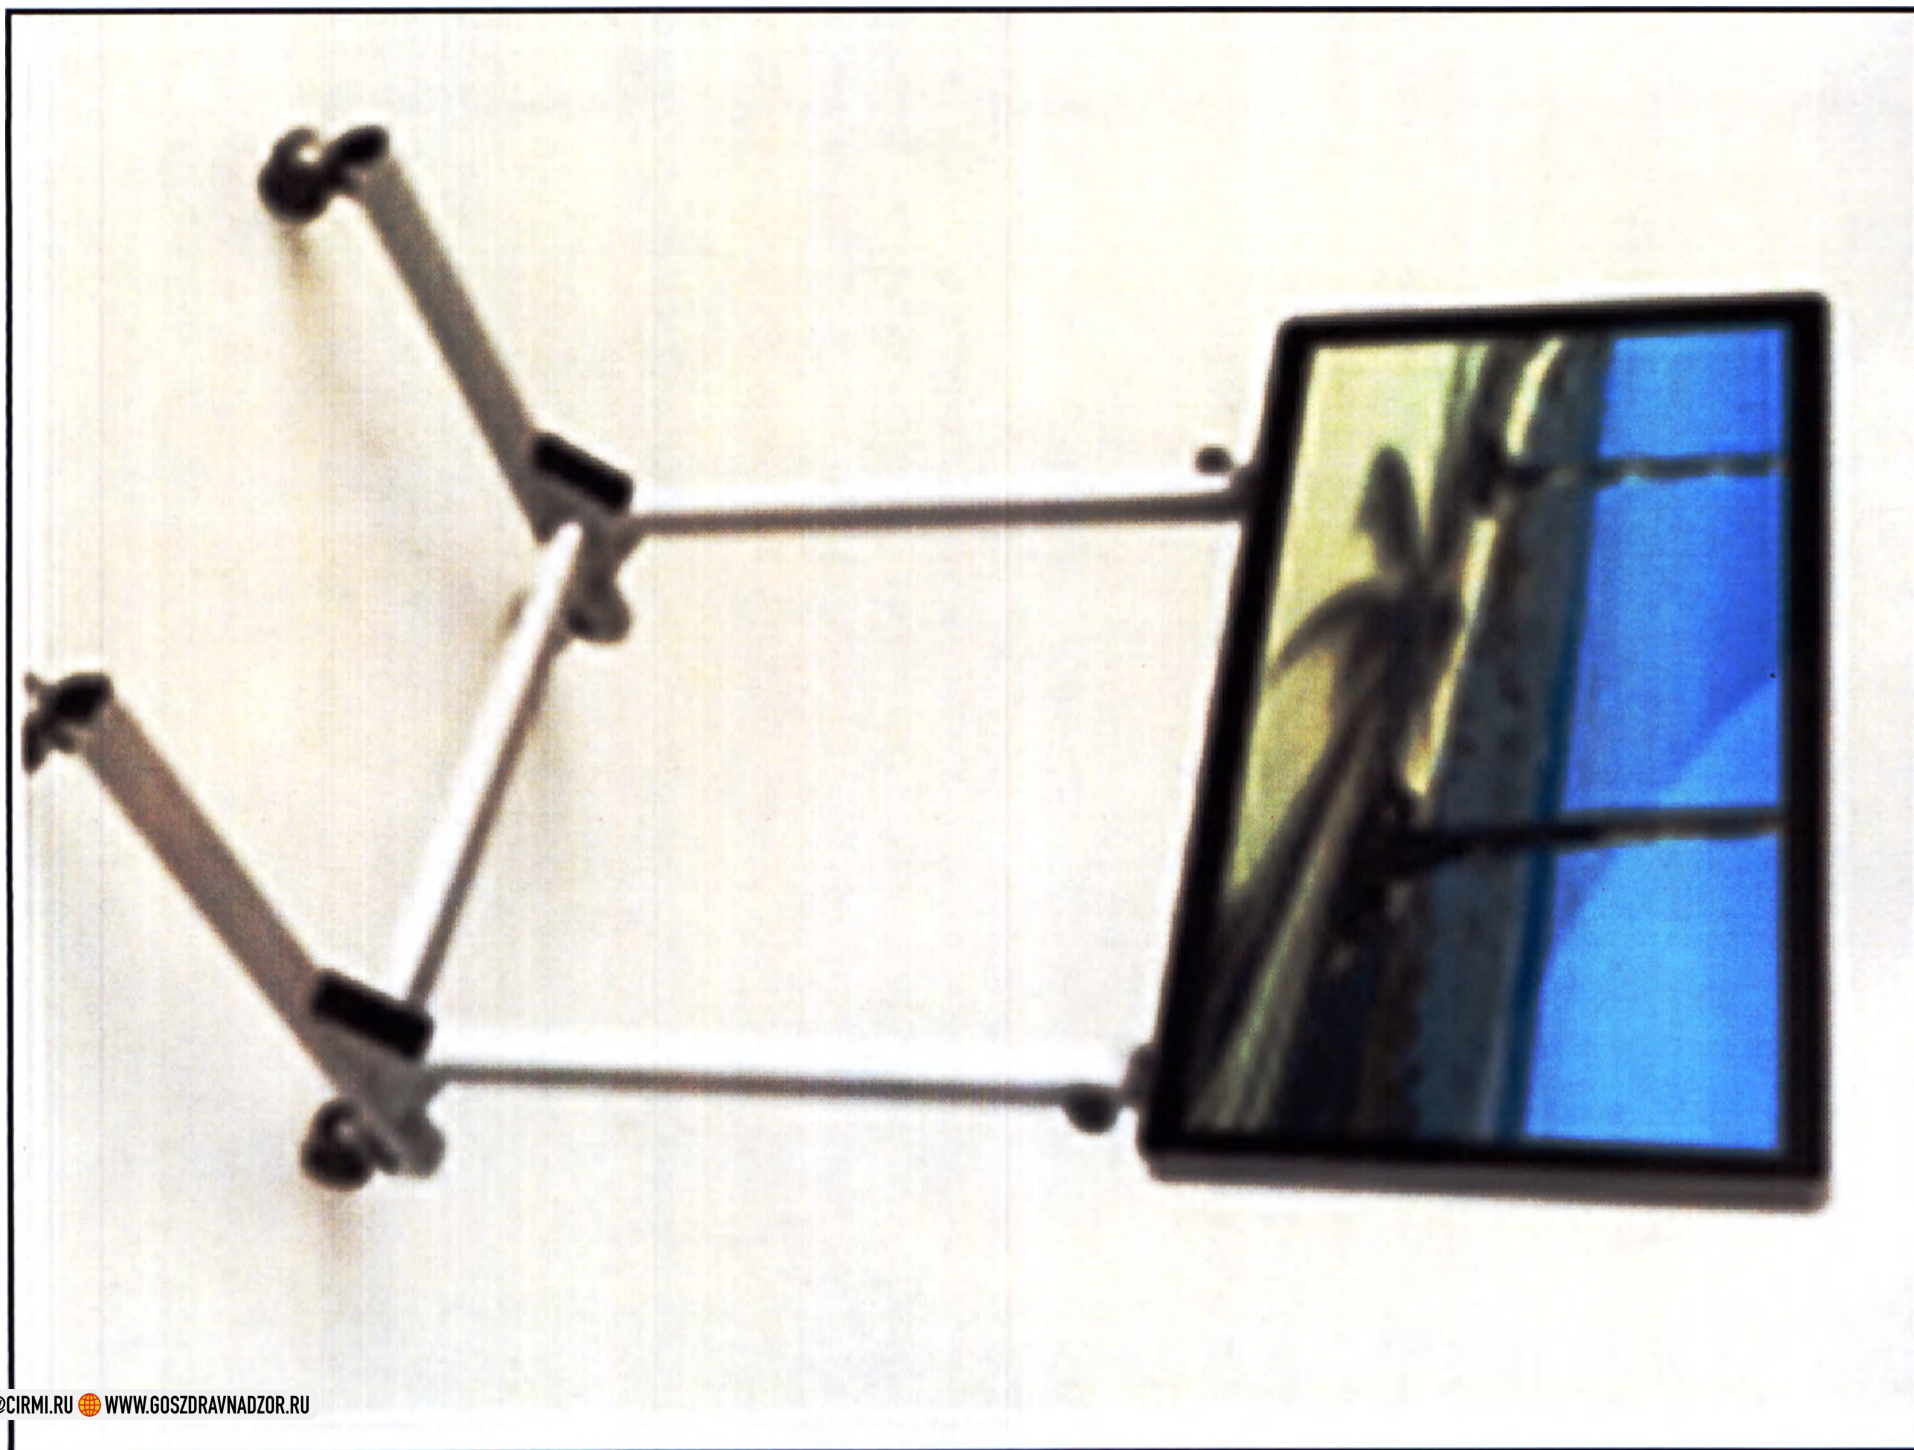


42. Охлаждающая жидкость (не более 100 шт.).



43. Чехлы для наушников к проигрывателю специальному немагнитному (не более 150 шт.).



43. Чехлы для наушников к проигрывателю специальному немагнитному (не более 150 шт.).

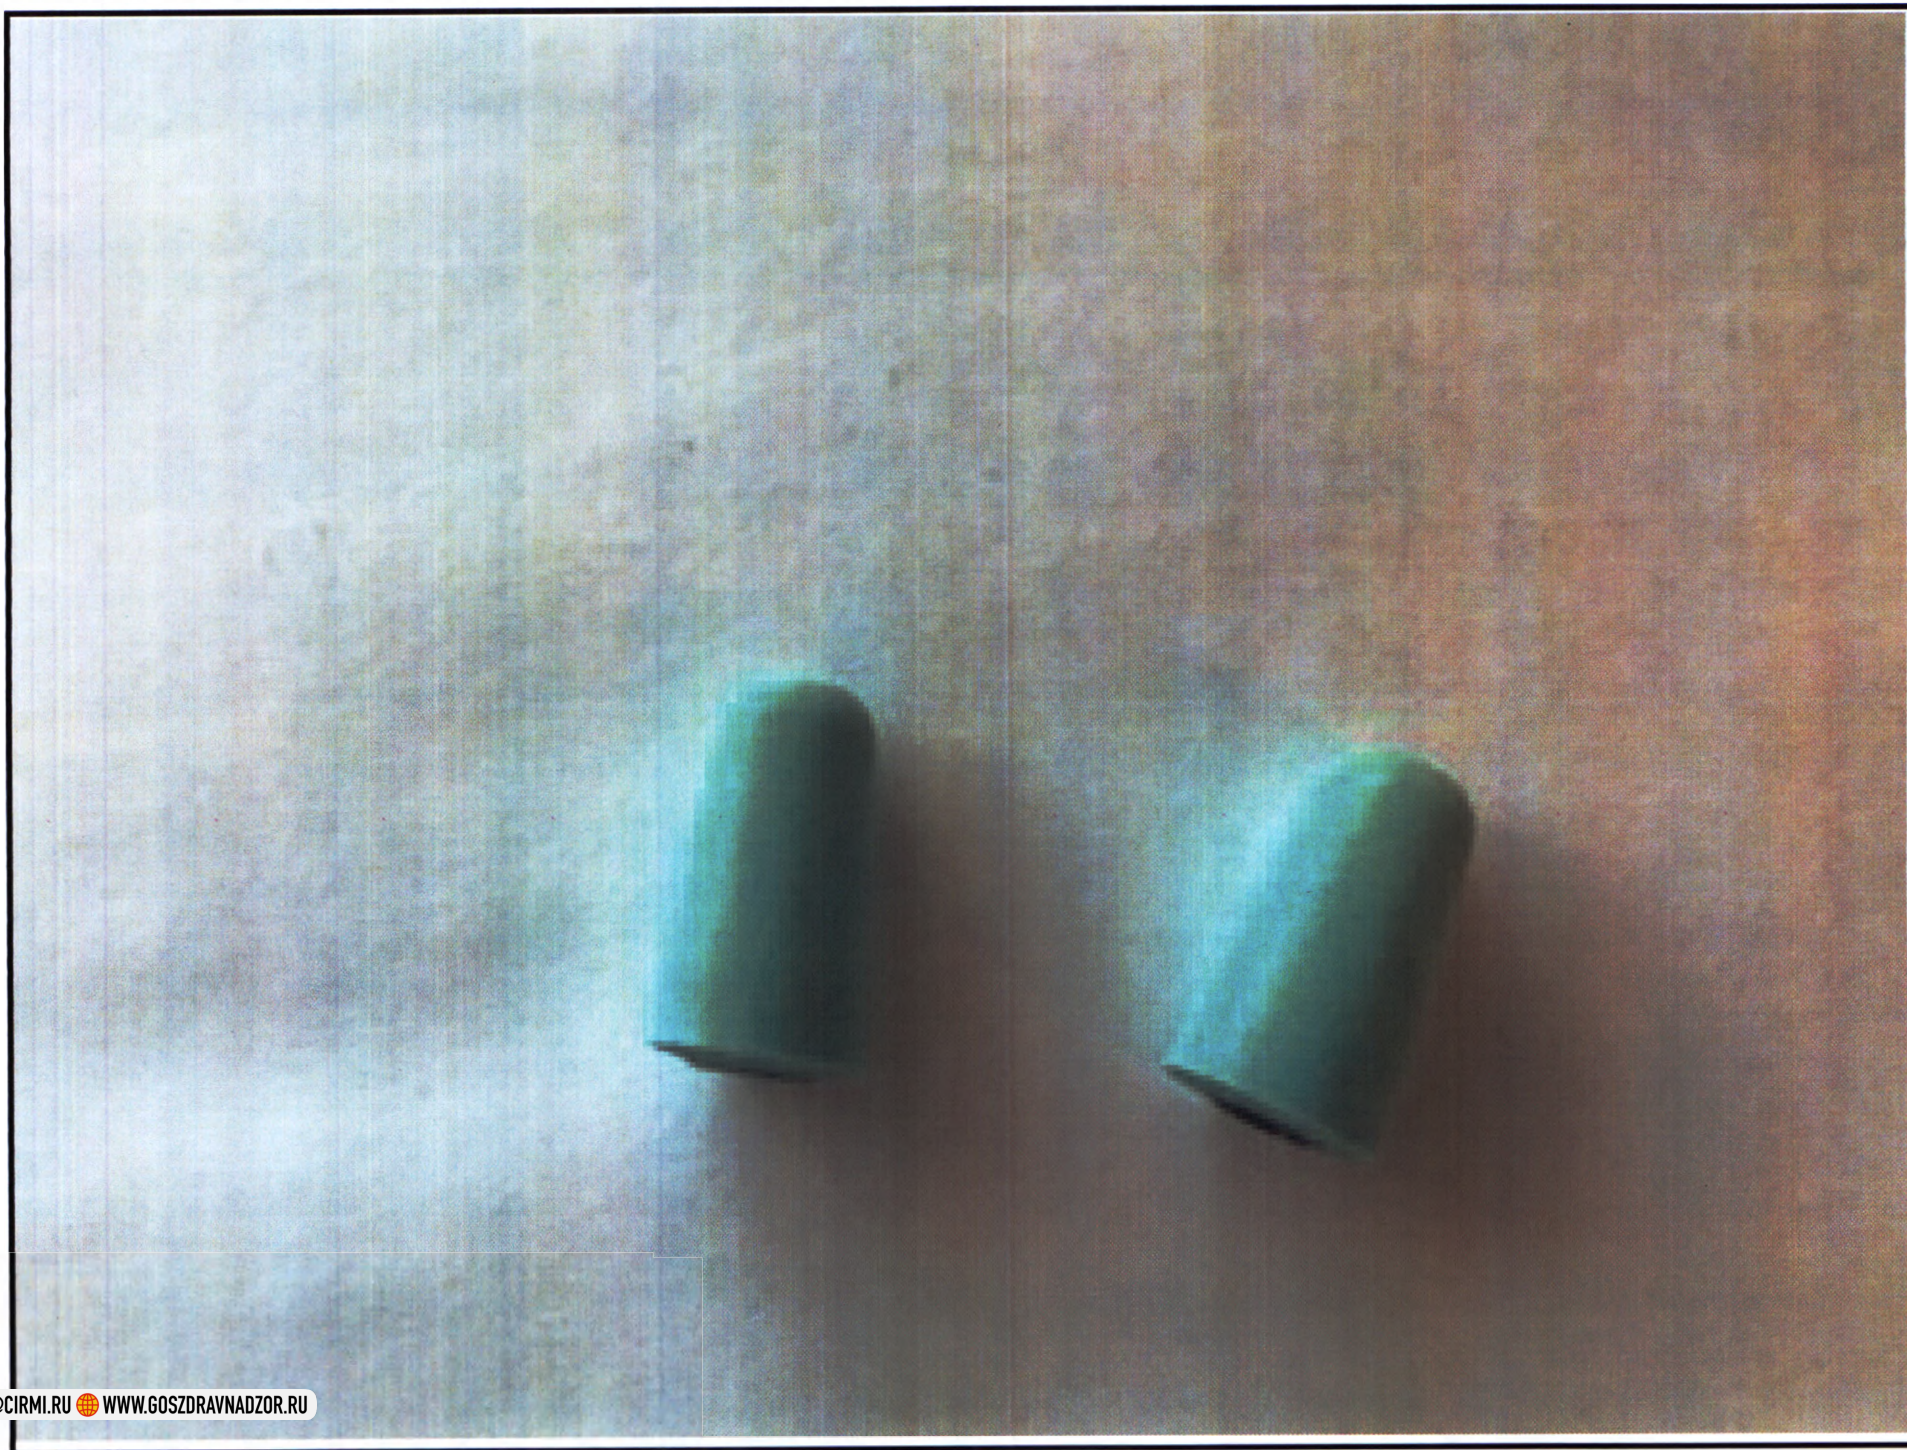


44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.



44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.



44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.

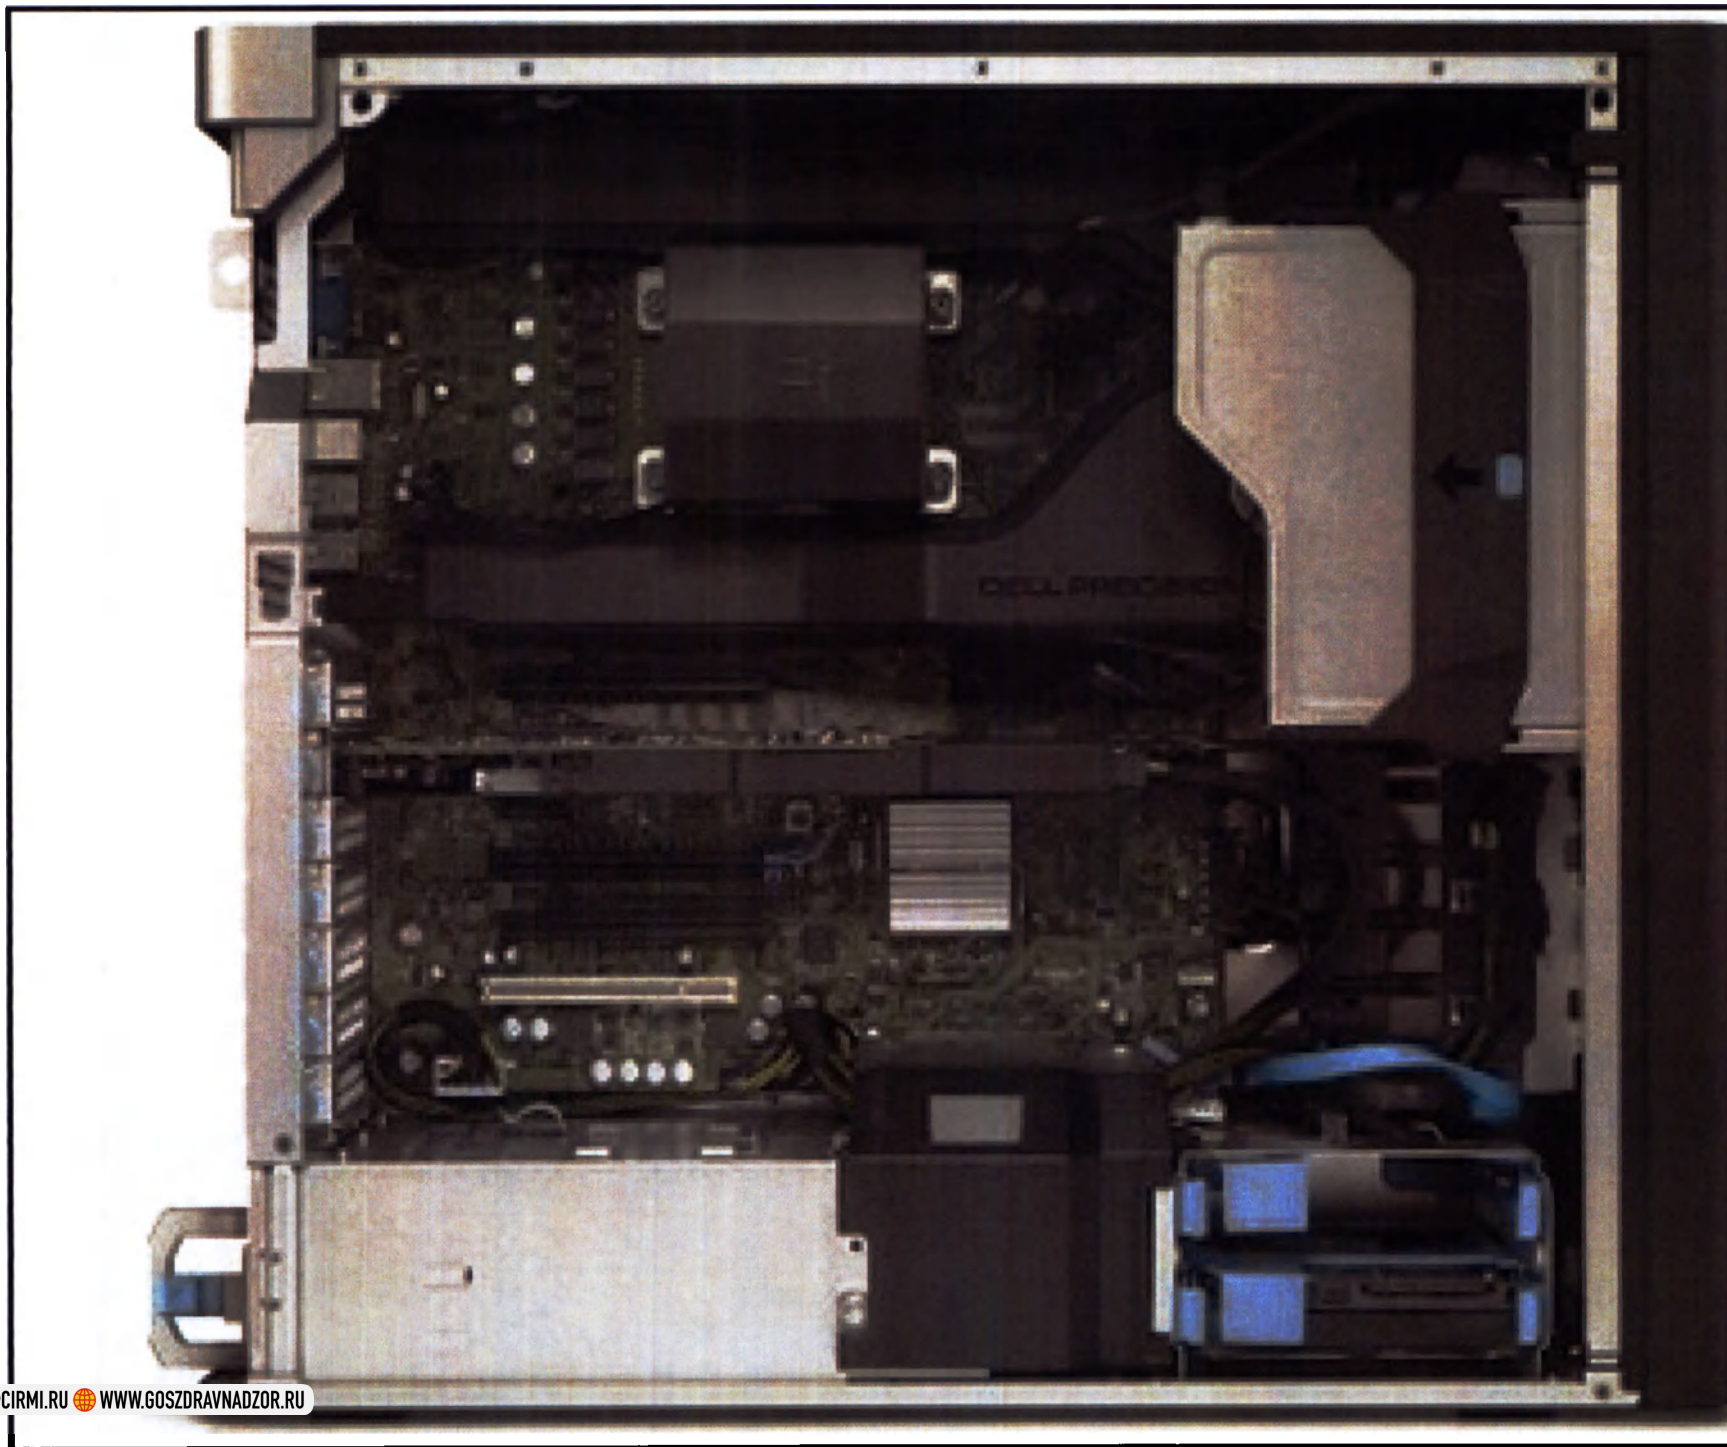

44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.



44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.




44. Вспомогательное оборудование для обработки результатов.




45. Сервисный ключ (не более 10 шт.).



45. Сервисный ключ (не более 10 шт.).

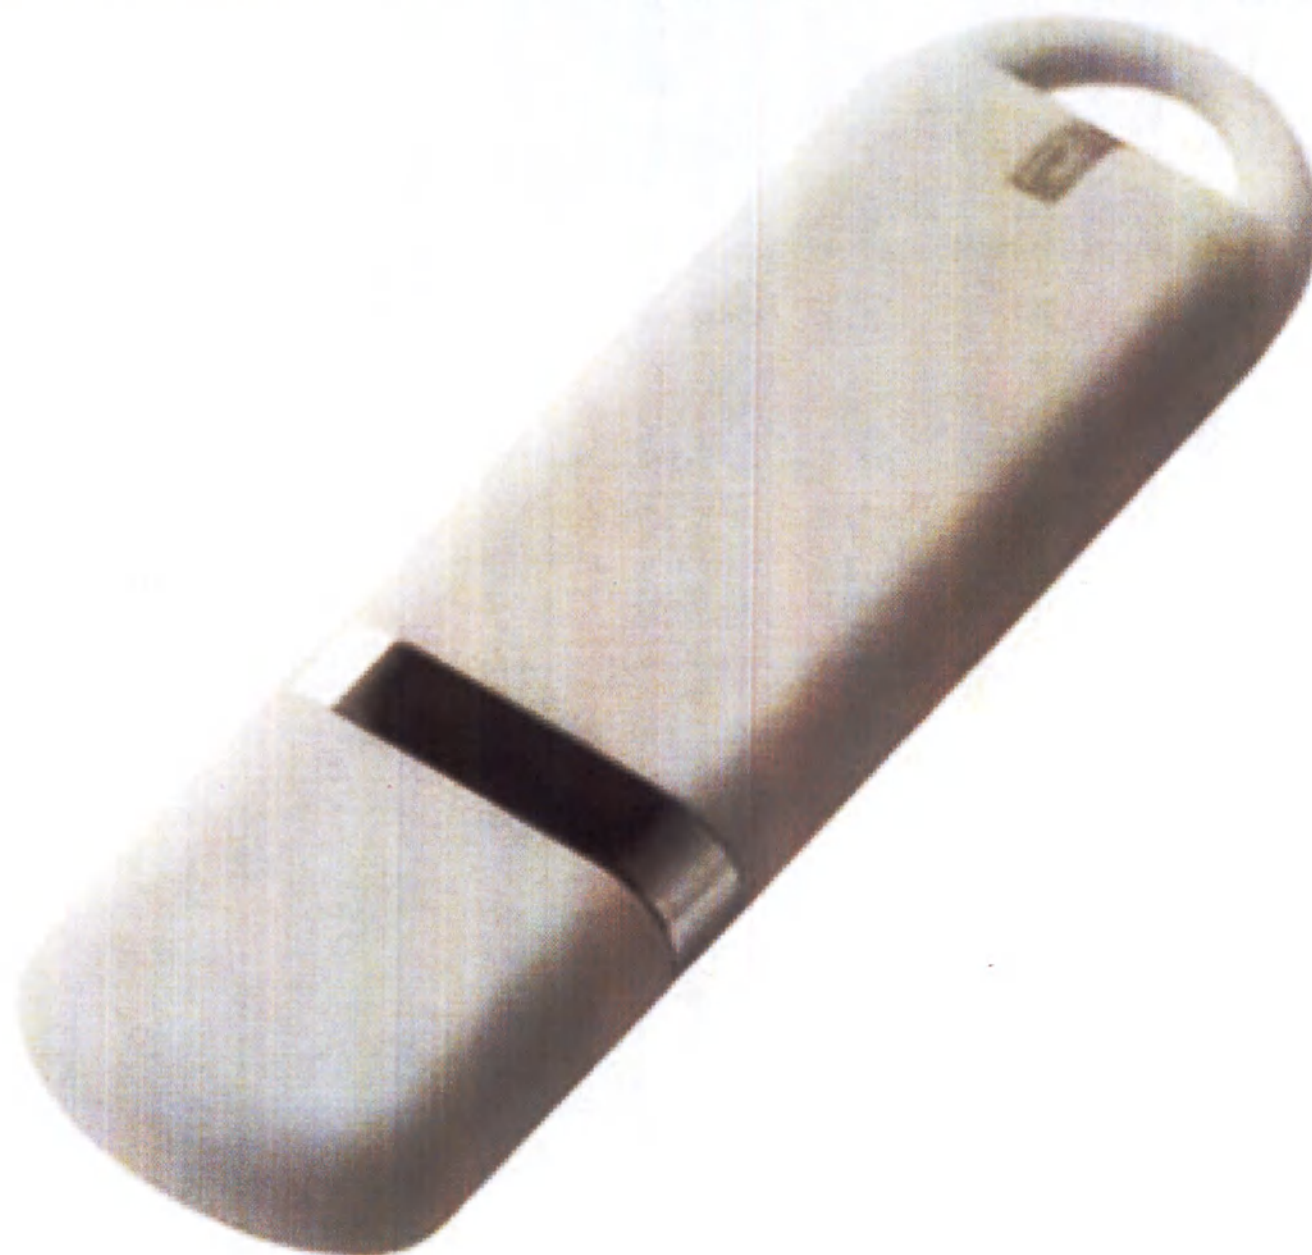

46. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии.

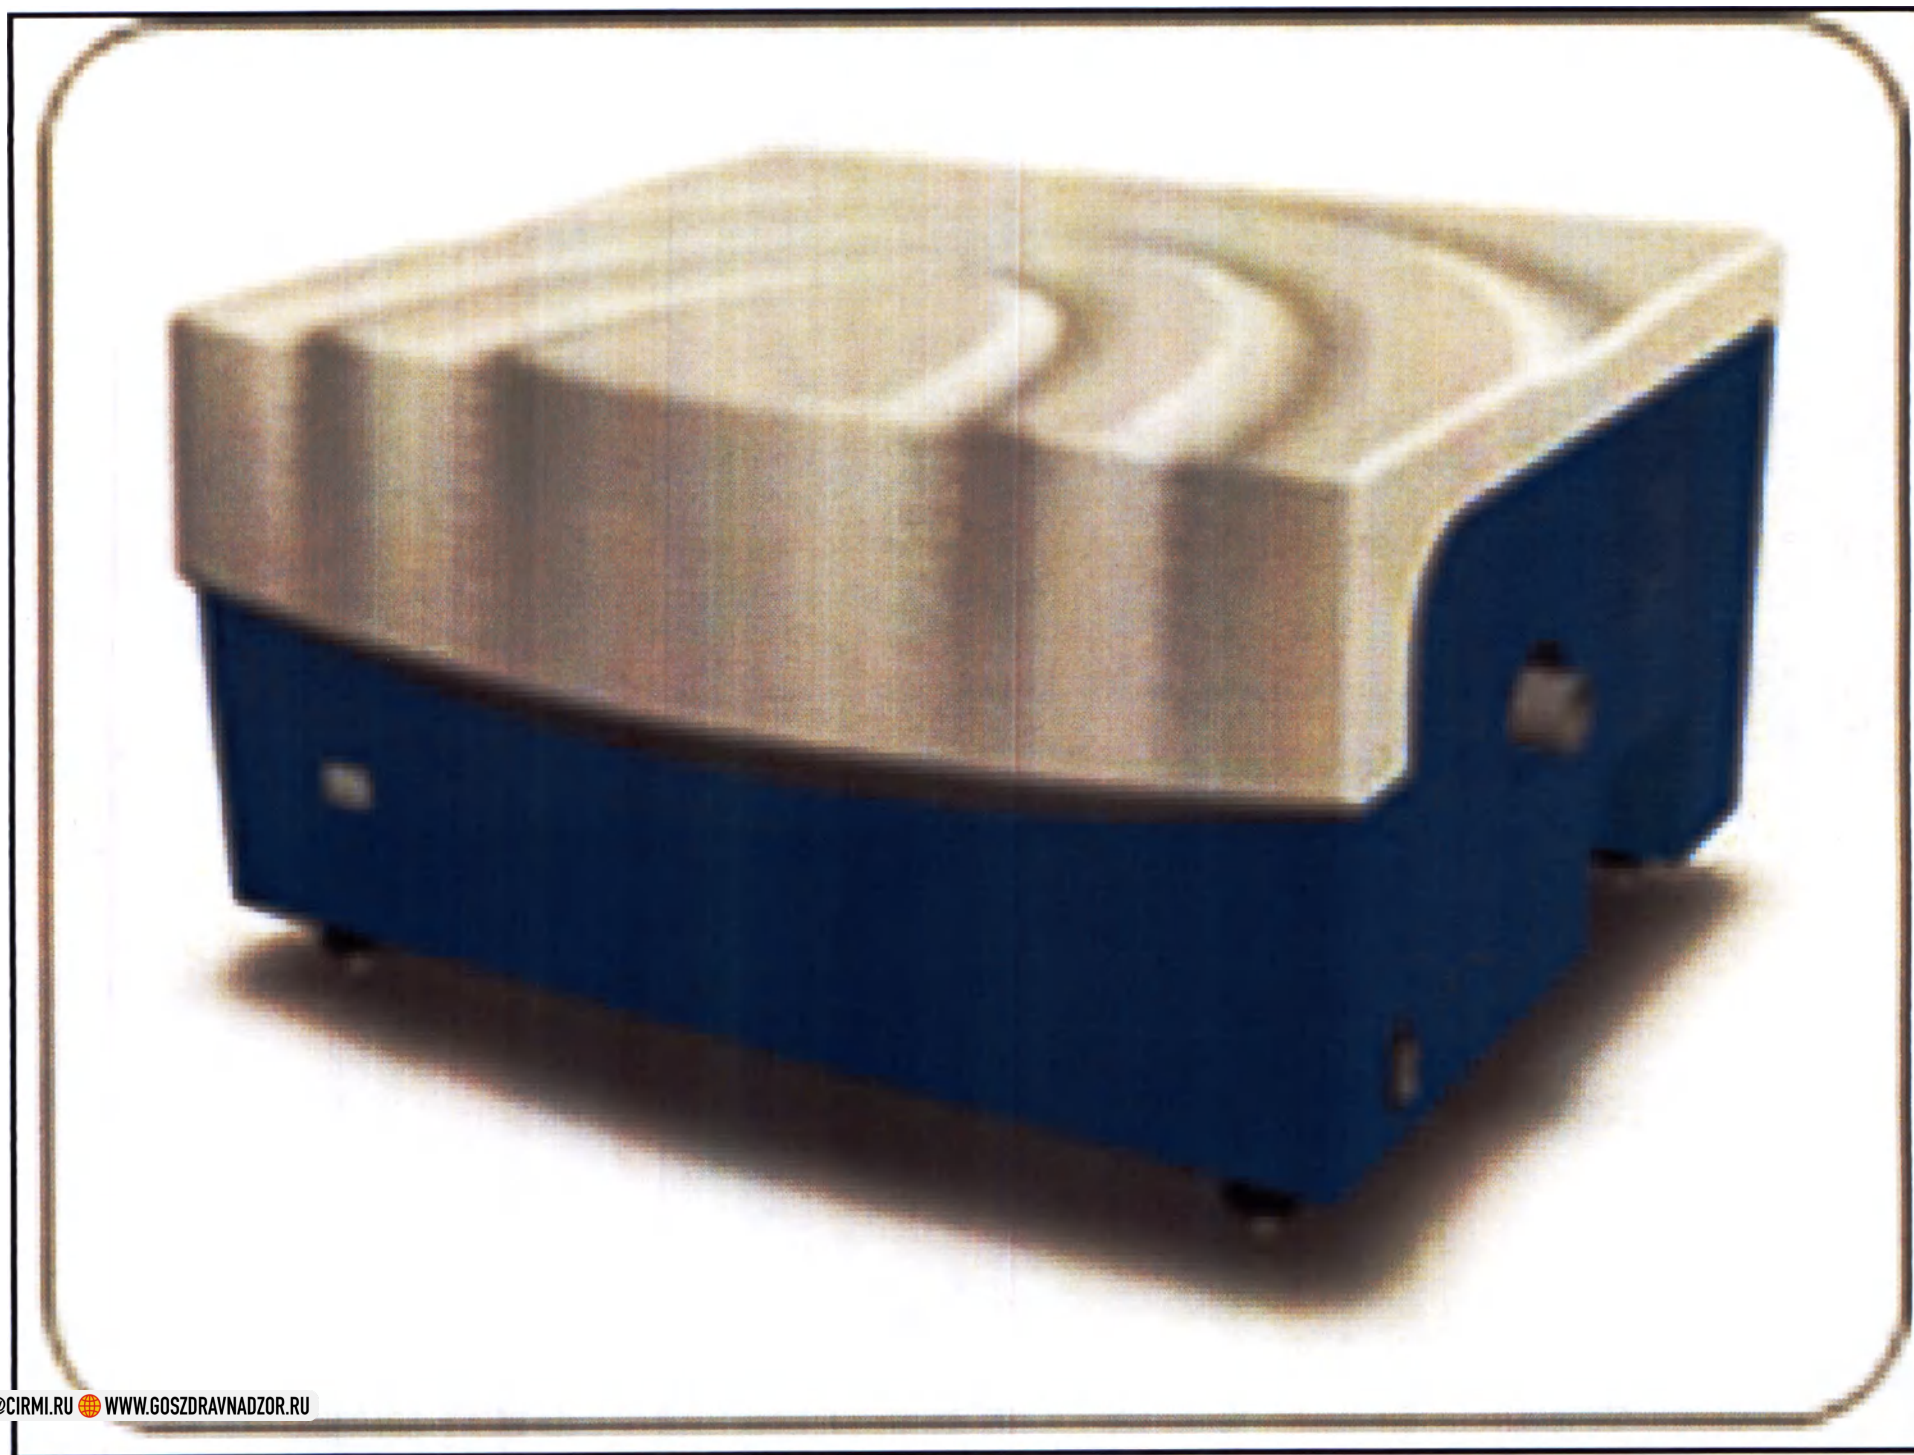


46. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии.




46. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии.




46. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии.

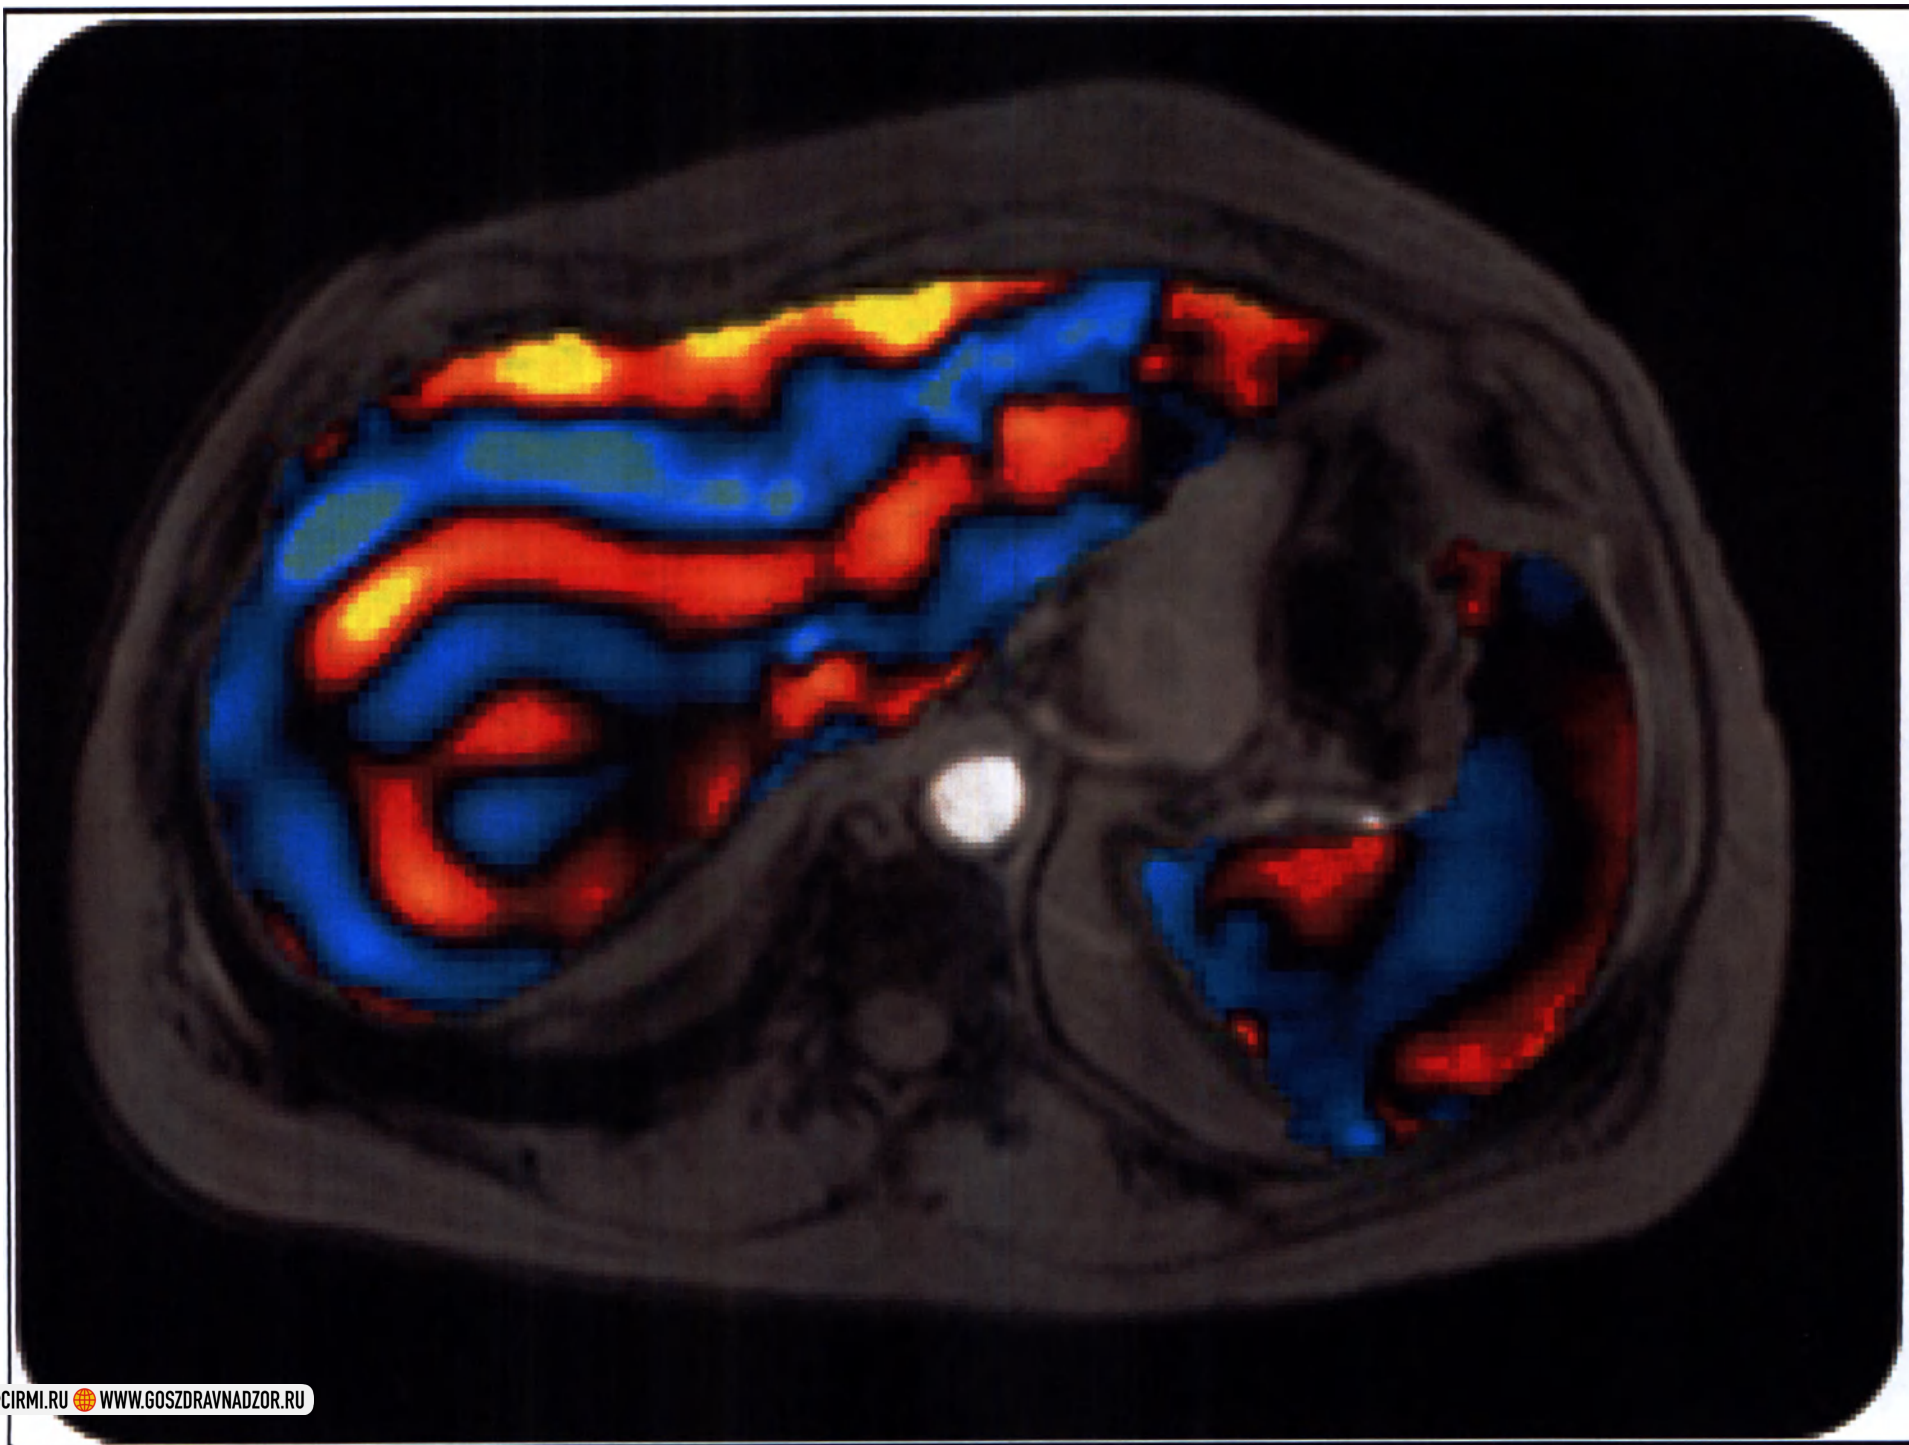

46. Программное обеспечение и аппаратный компонент для получения данных эластографии.

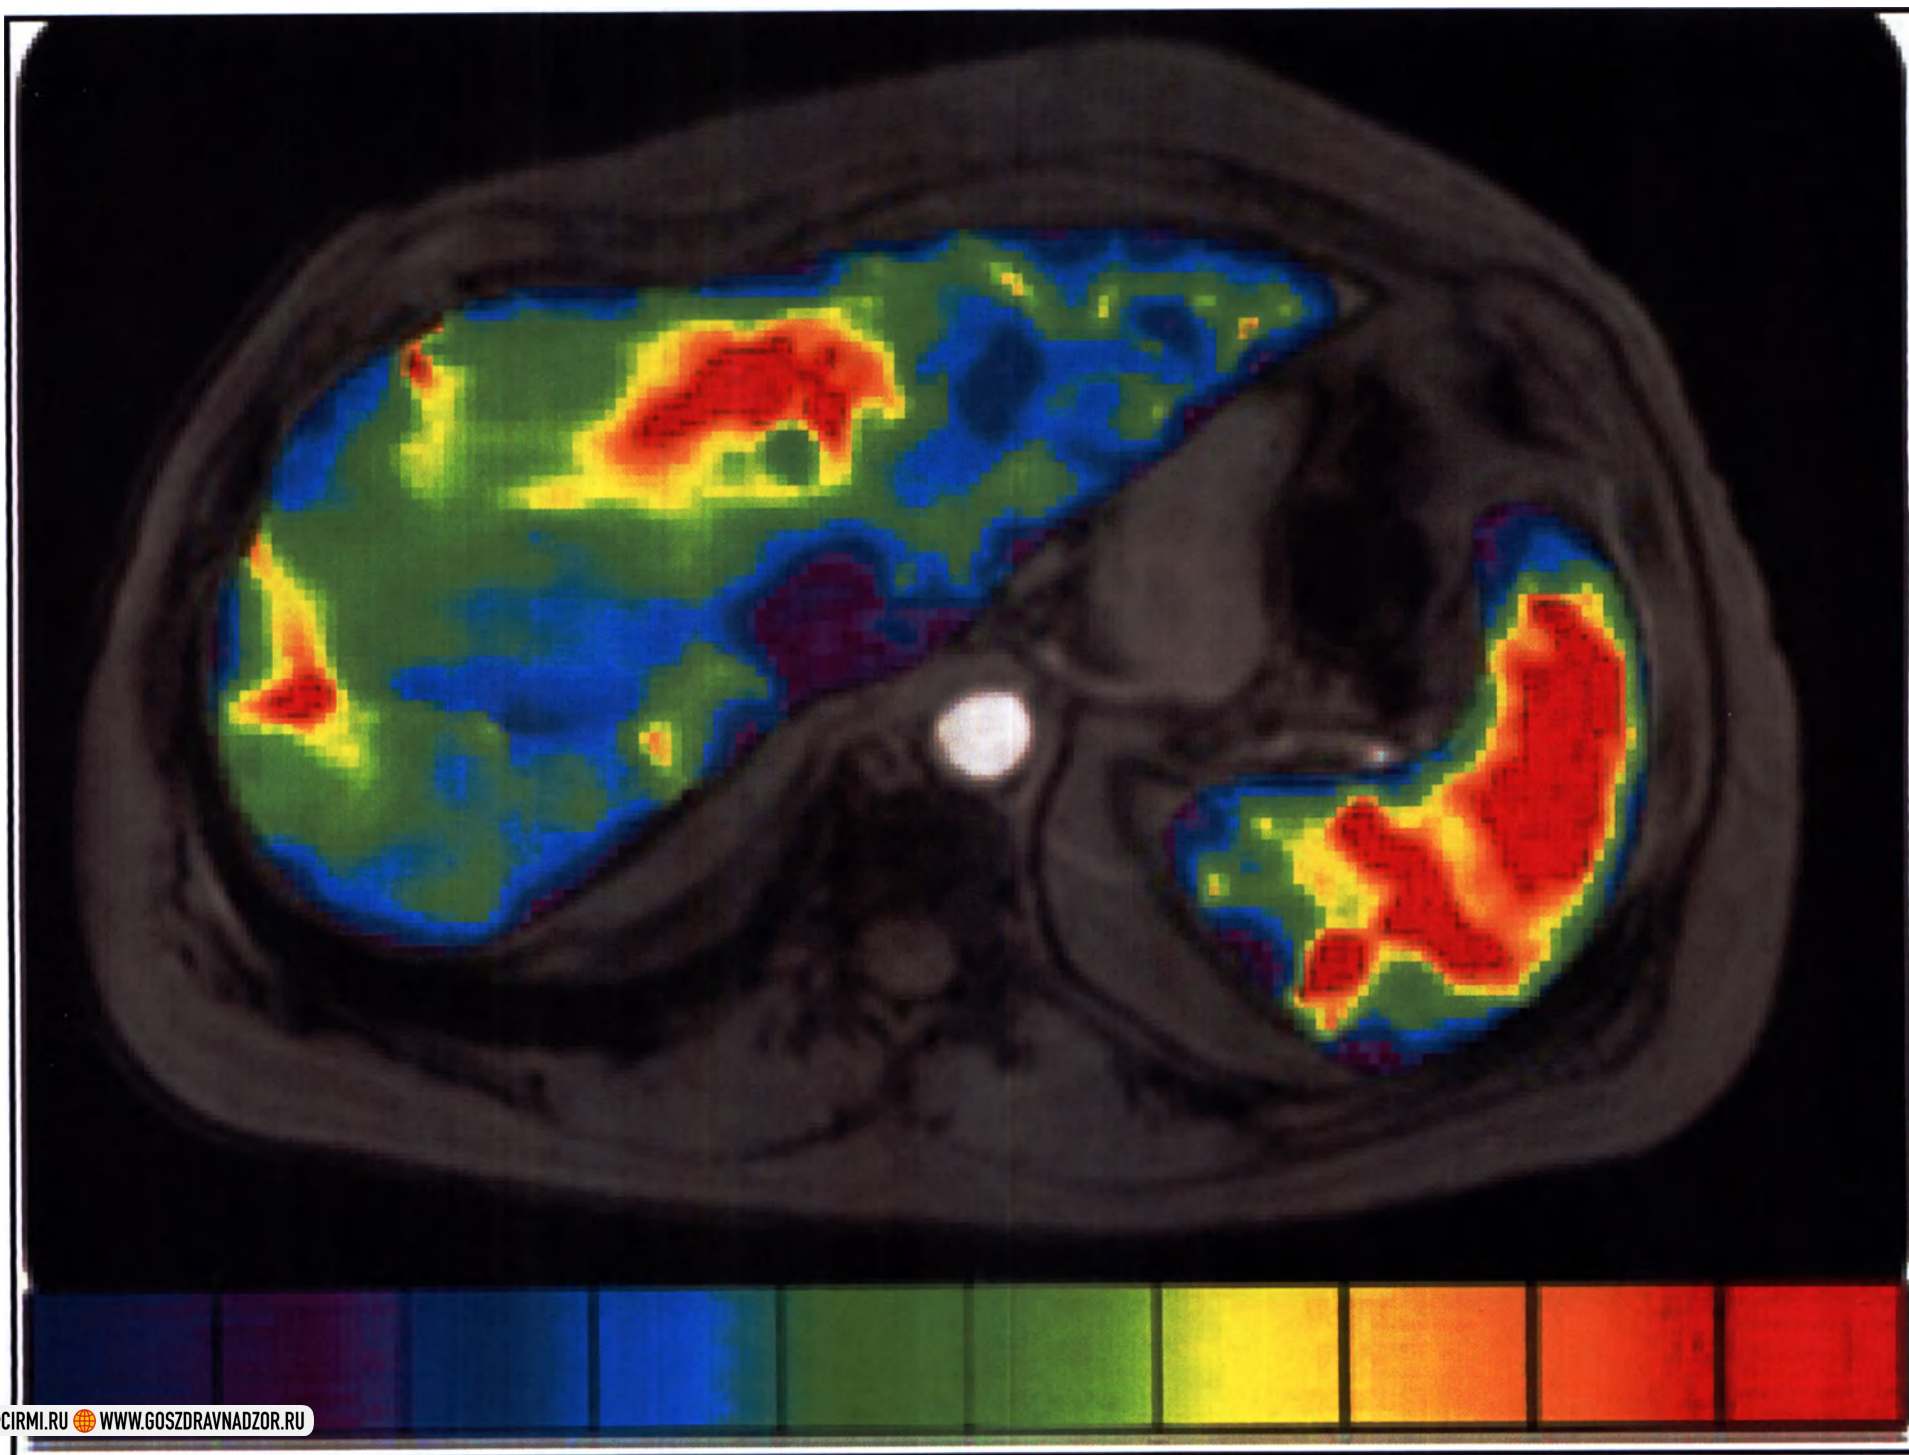

47. Кожухи (не более 50 шт.).

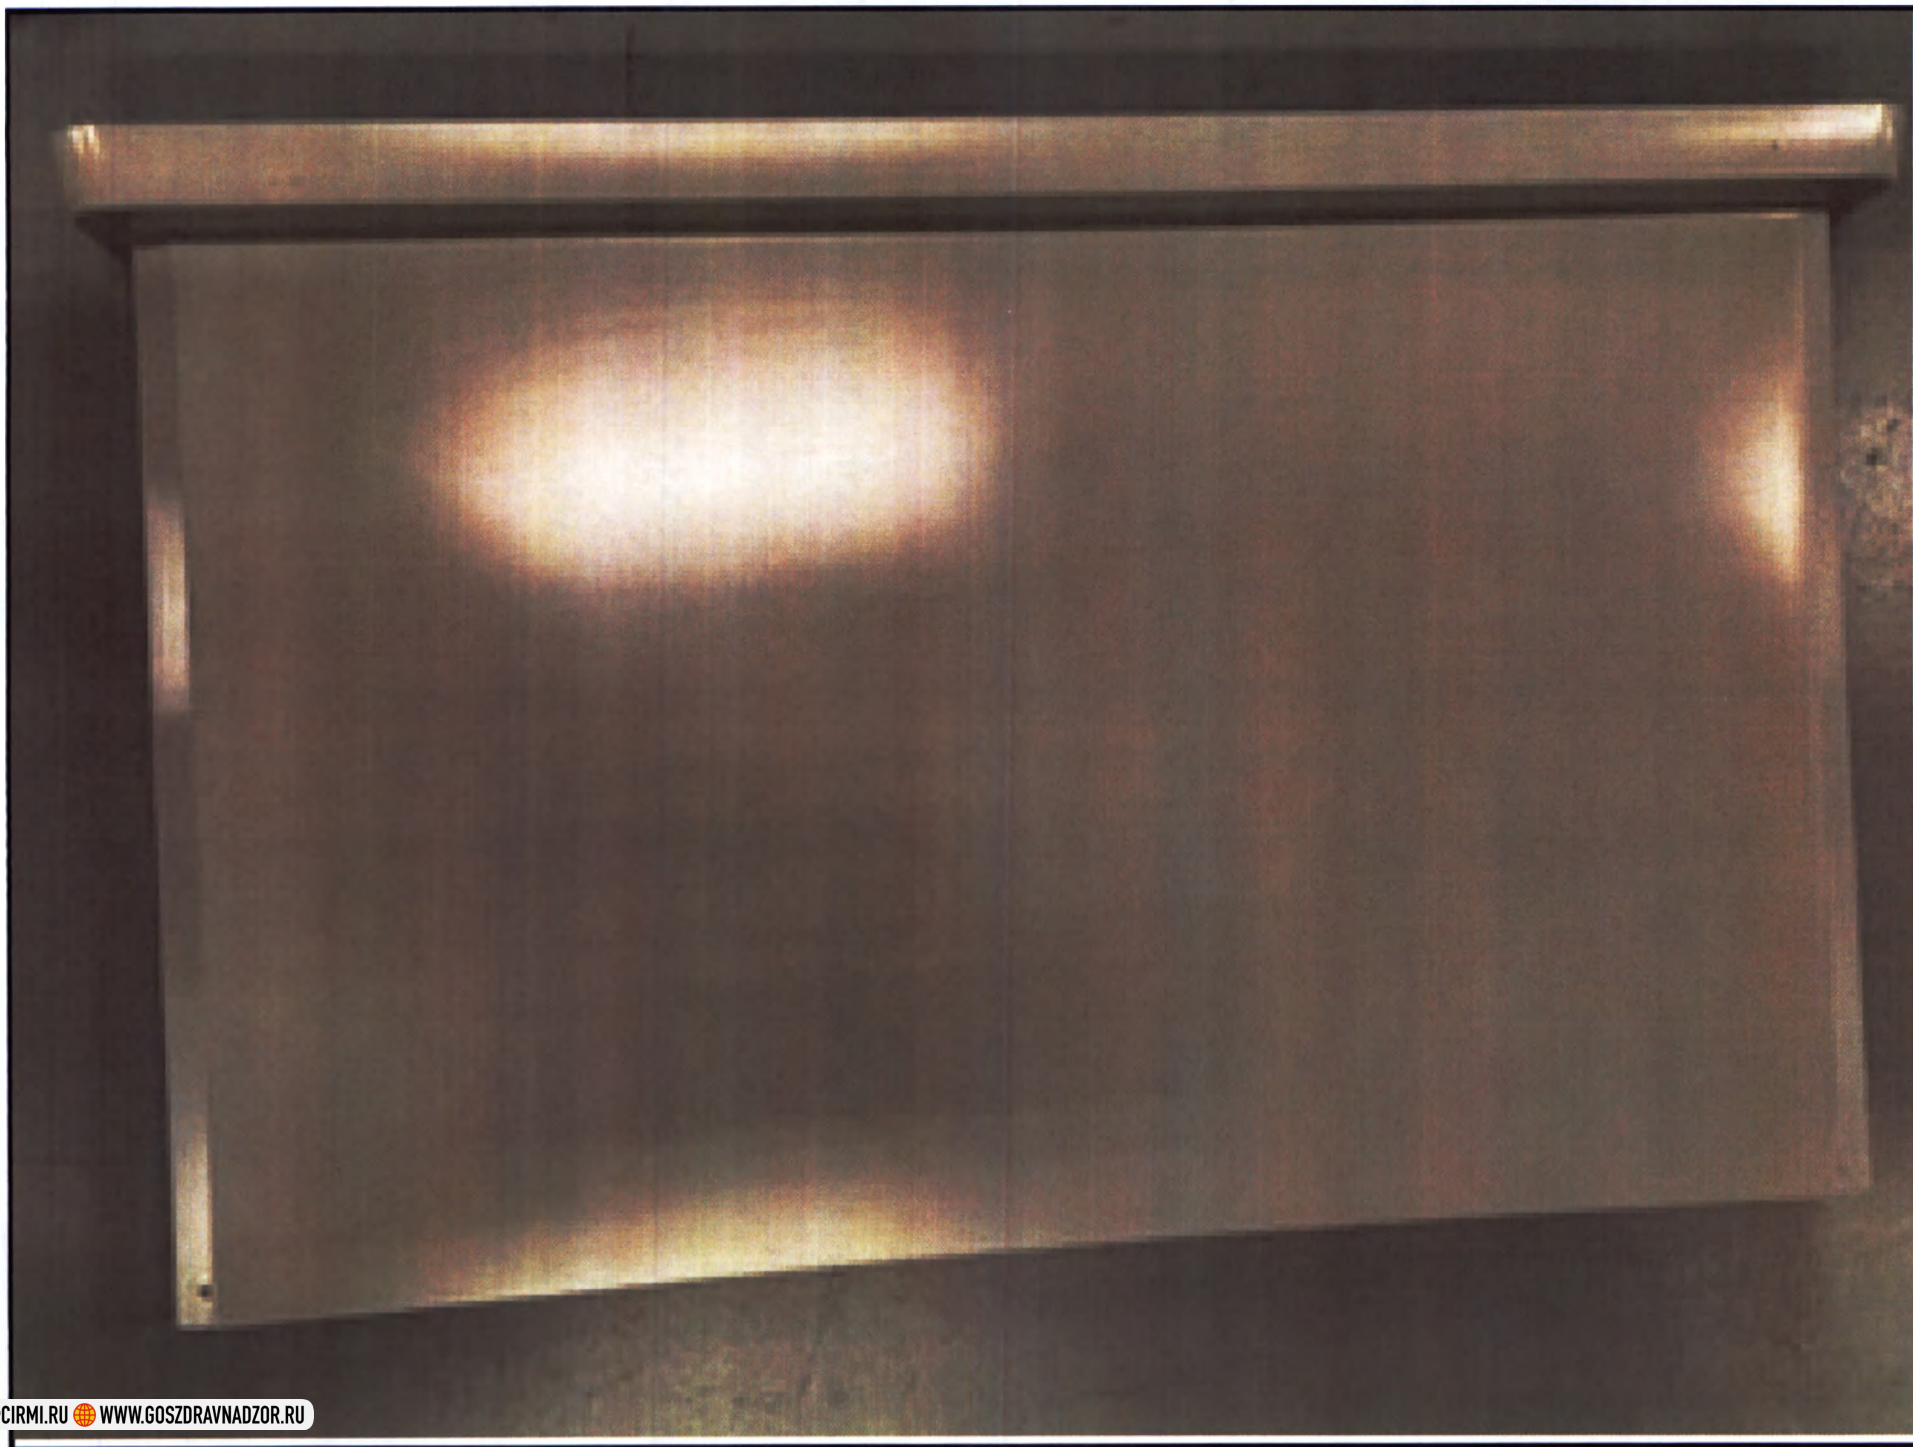


47. Кожухи (не более 50 шт.).




47. Кожухи (не более 50 шт.).




47. Кожухи (не более 50 шт.).

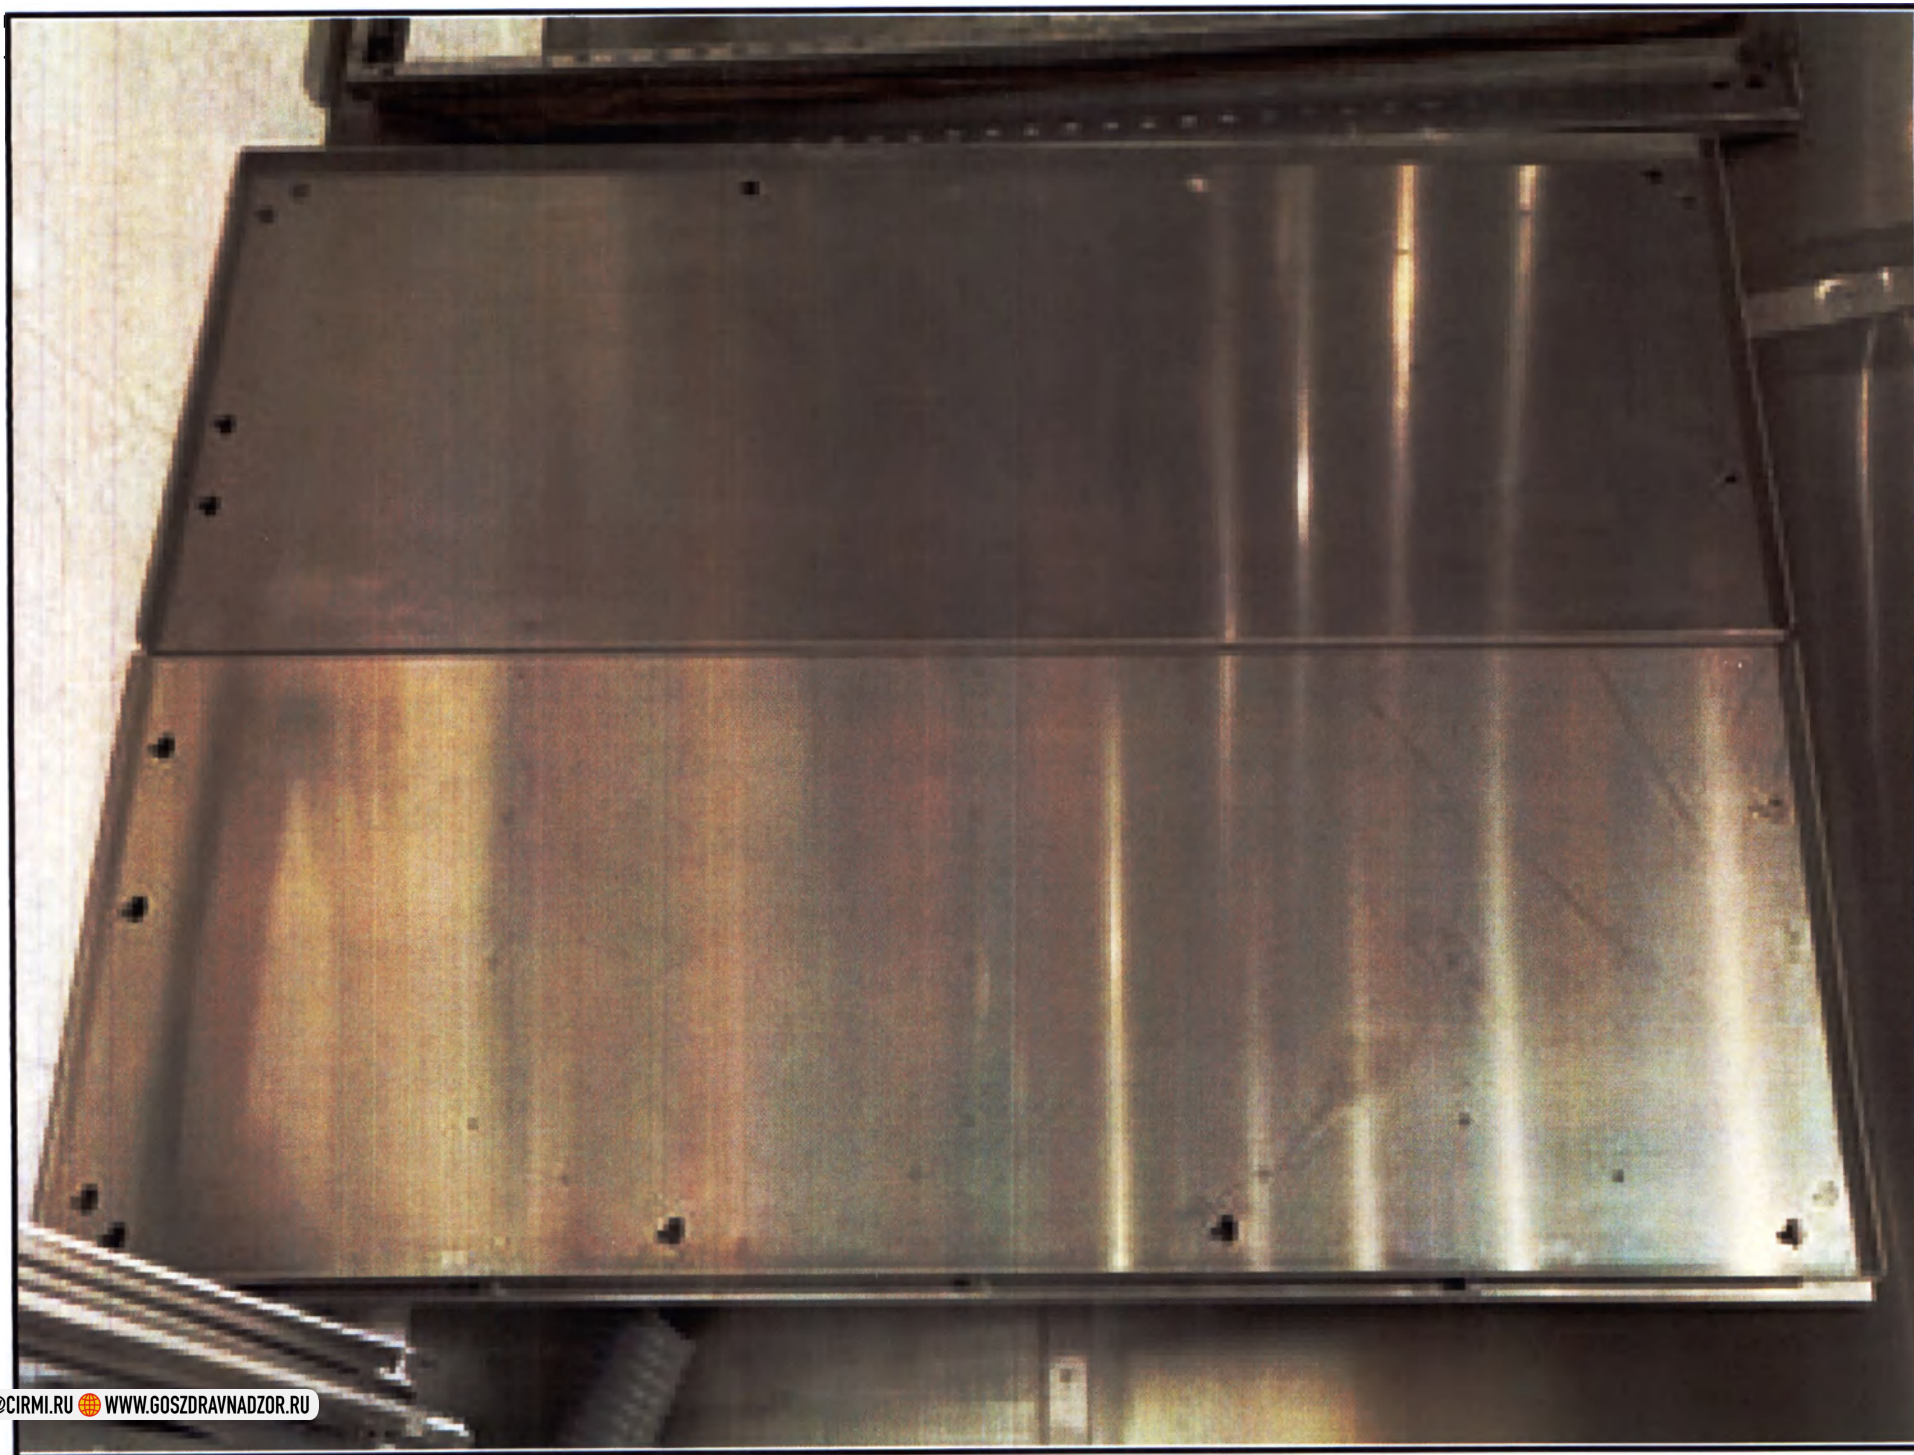


47. Кожухи (не более 50 шт.).

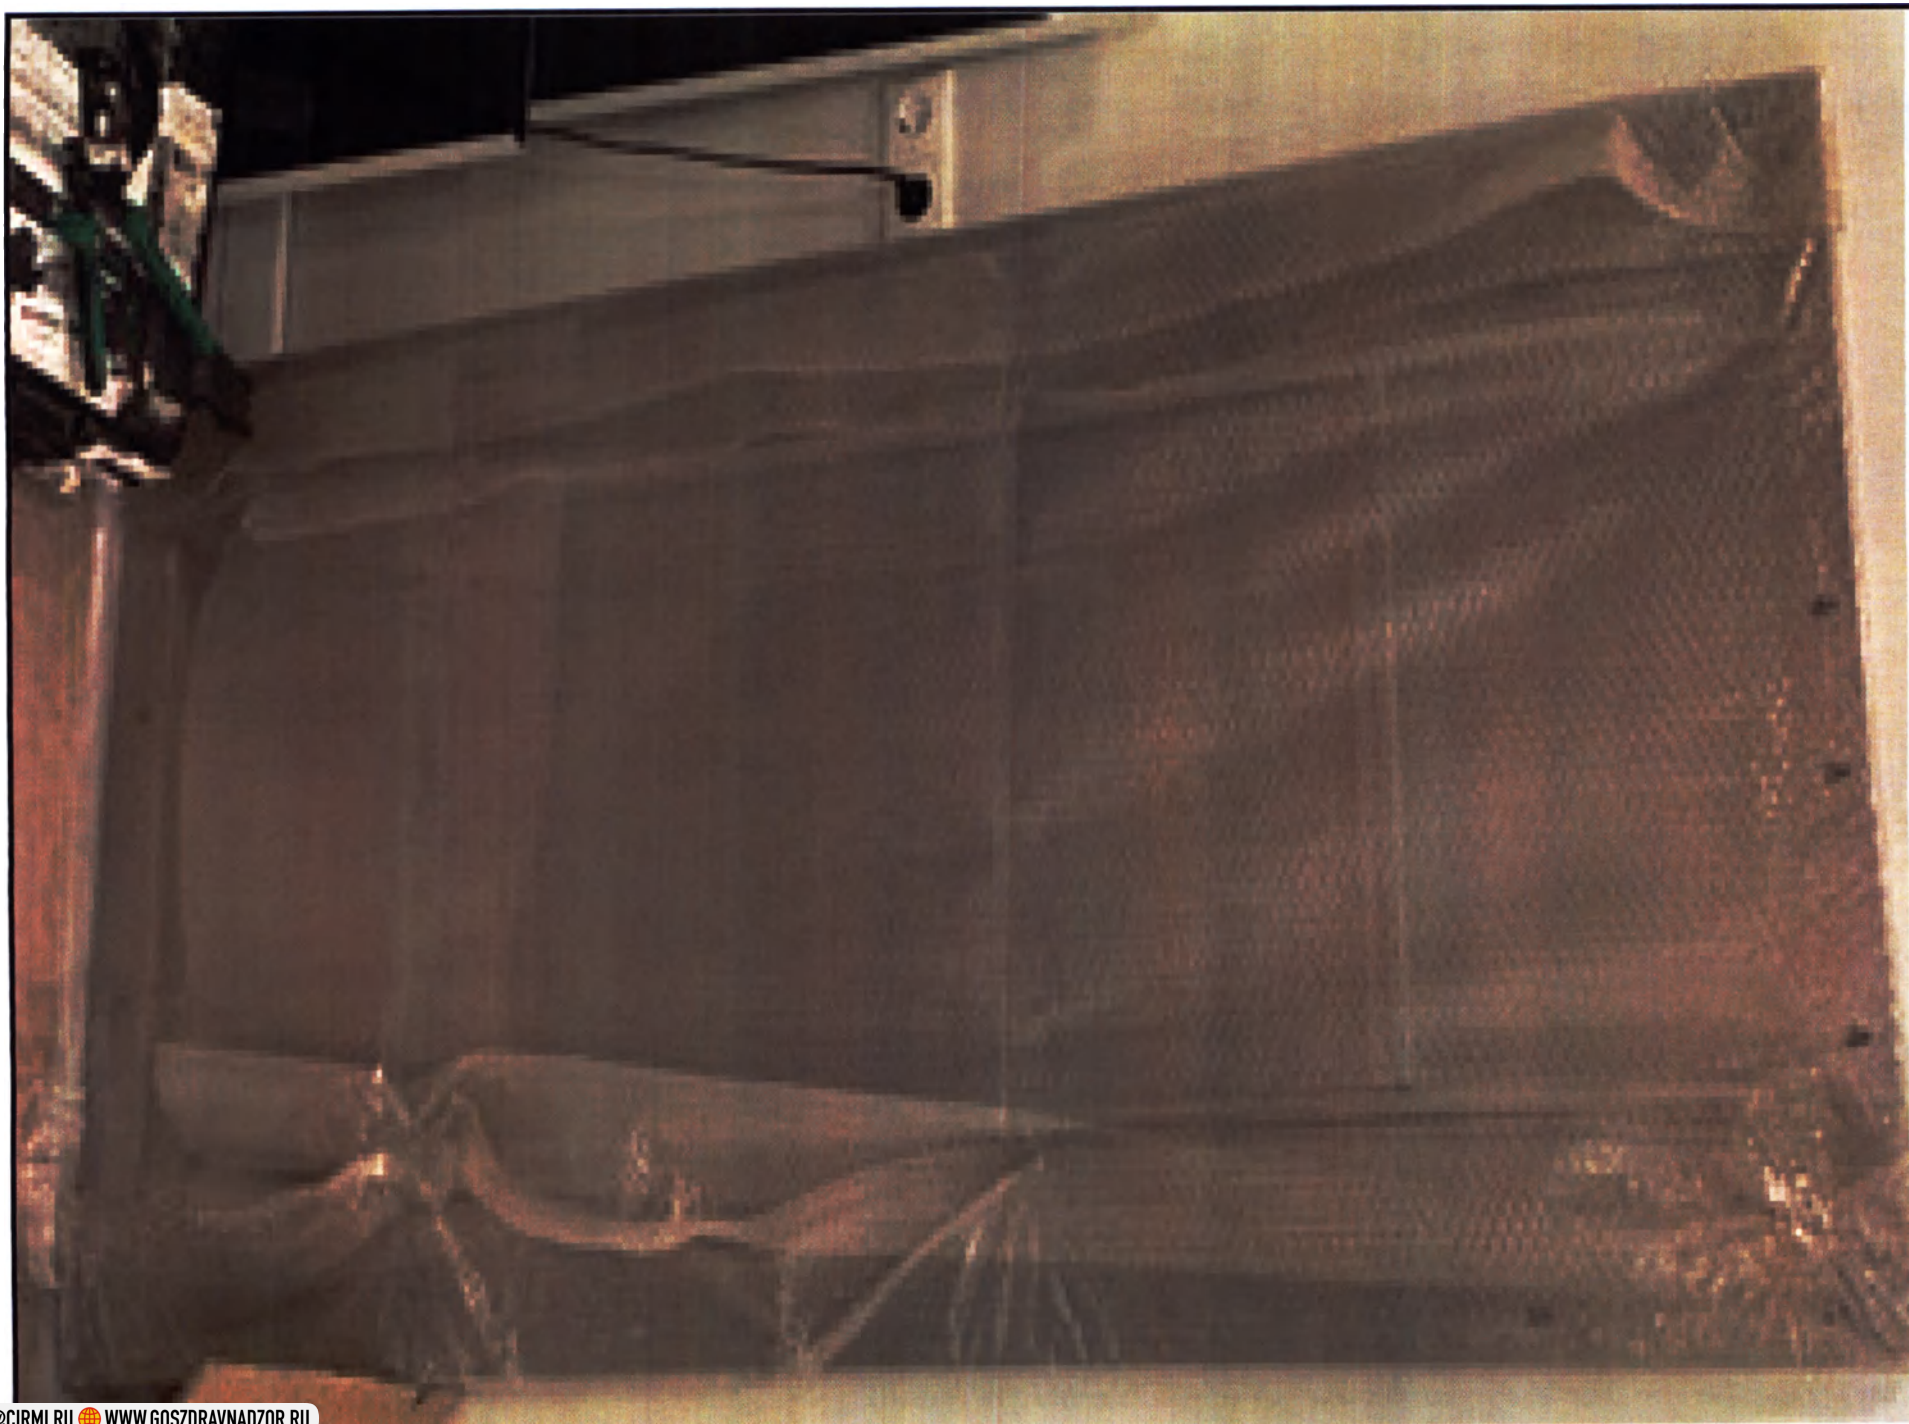

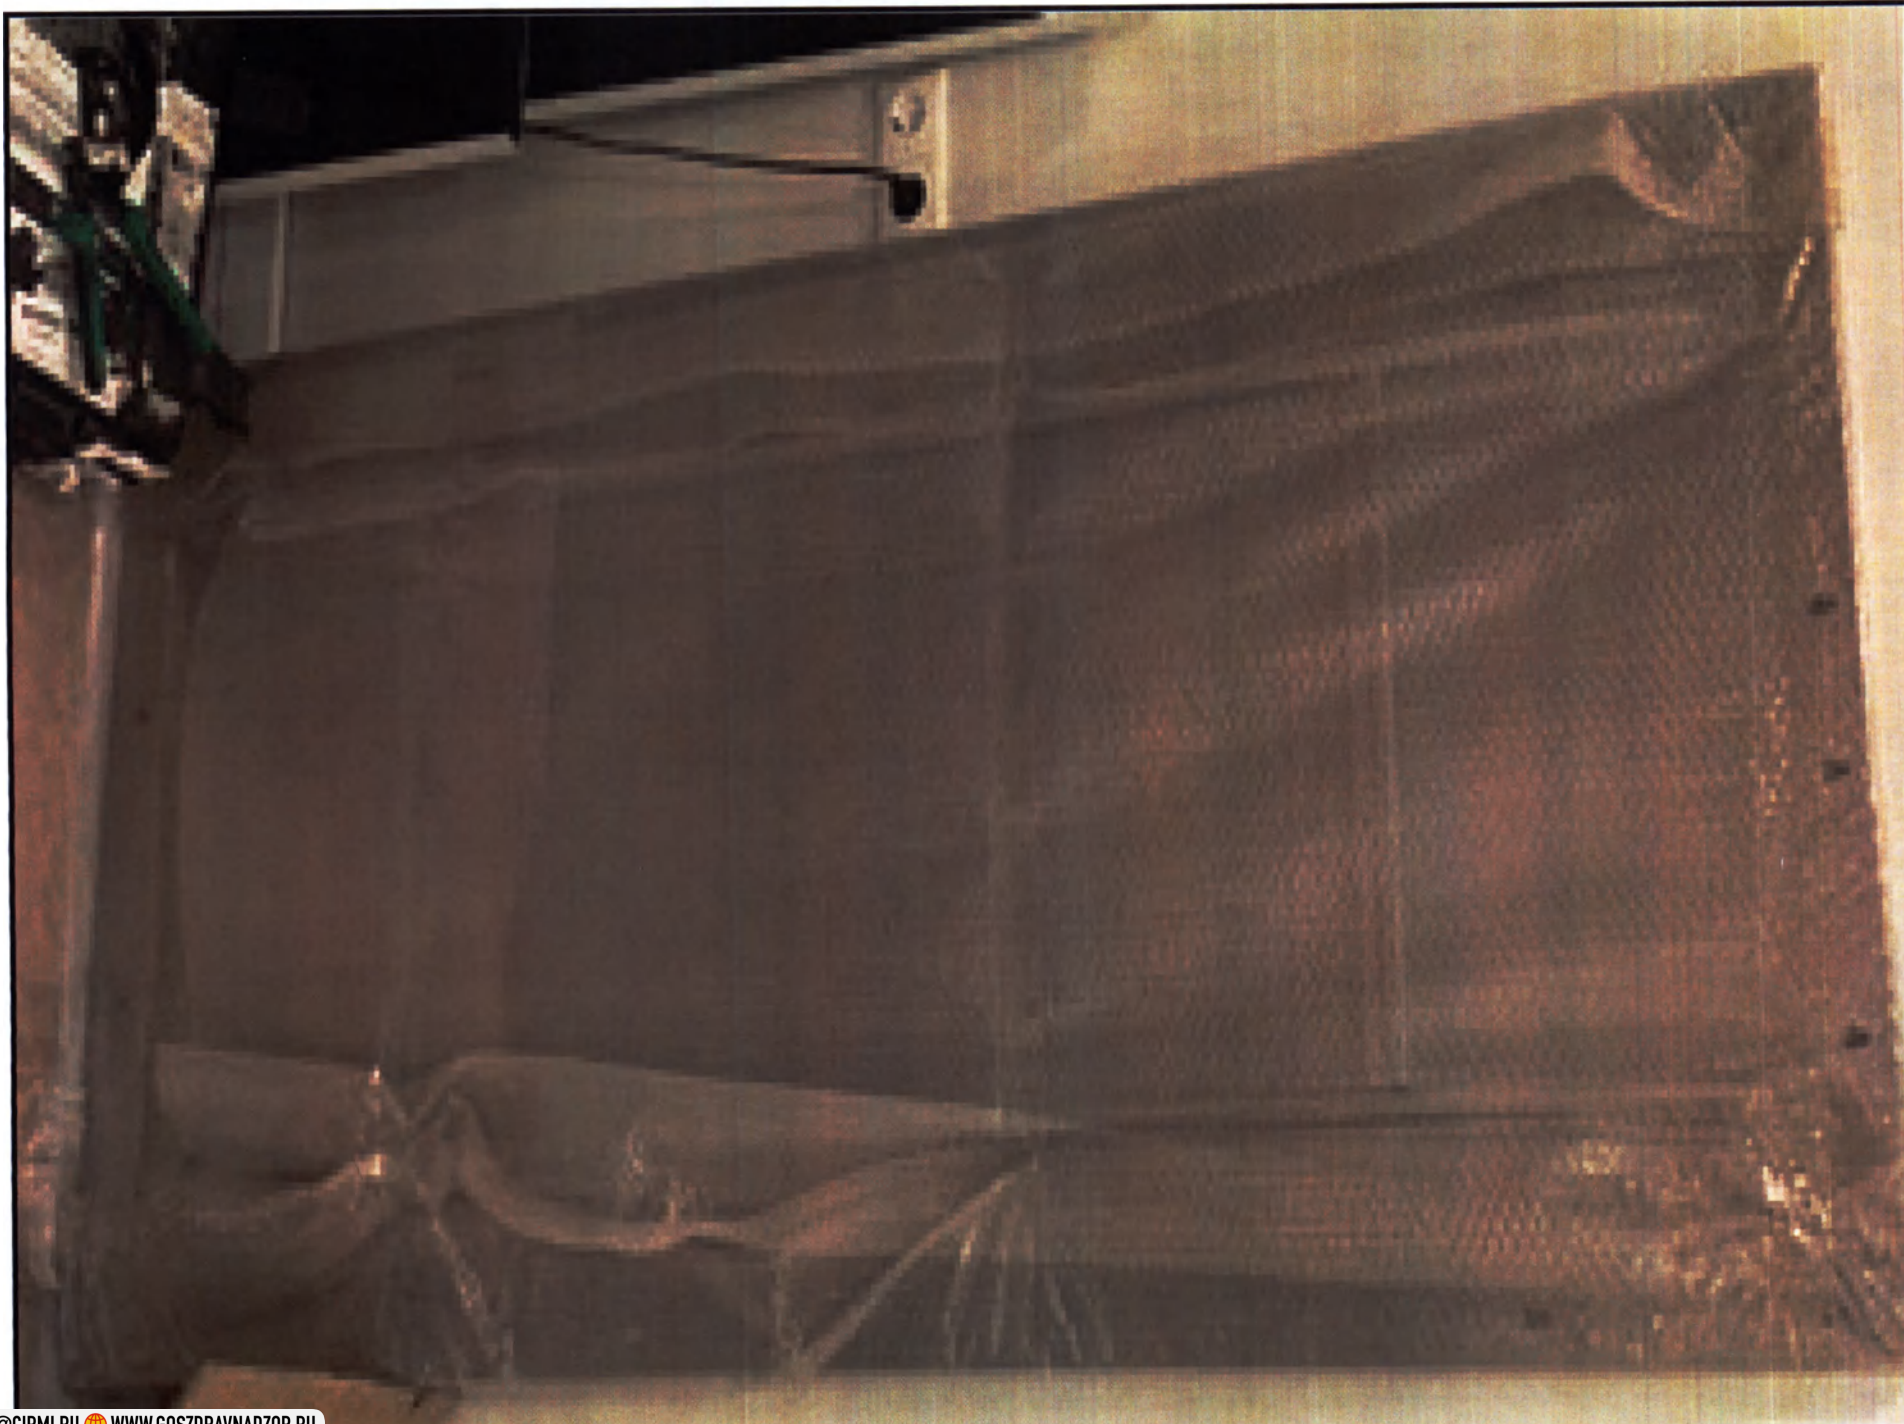


47. Кожухи (не более 50 шт.).

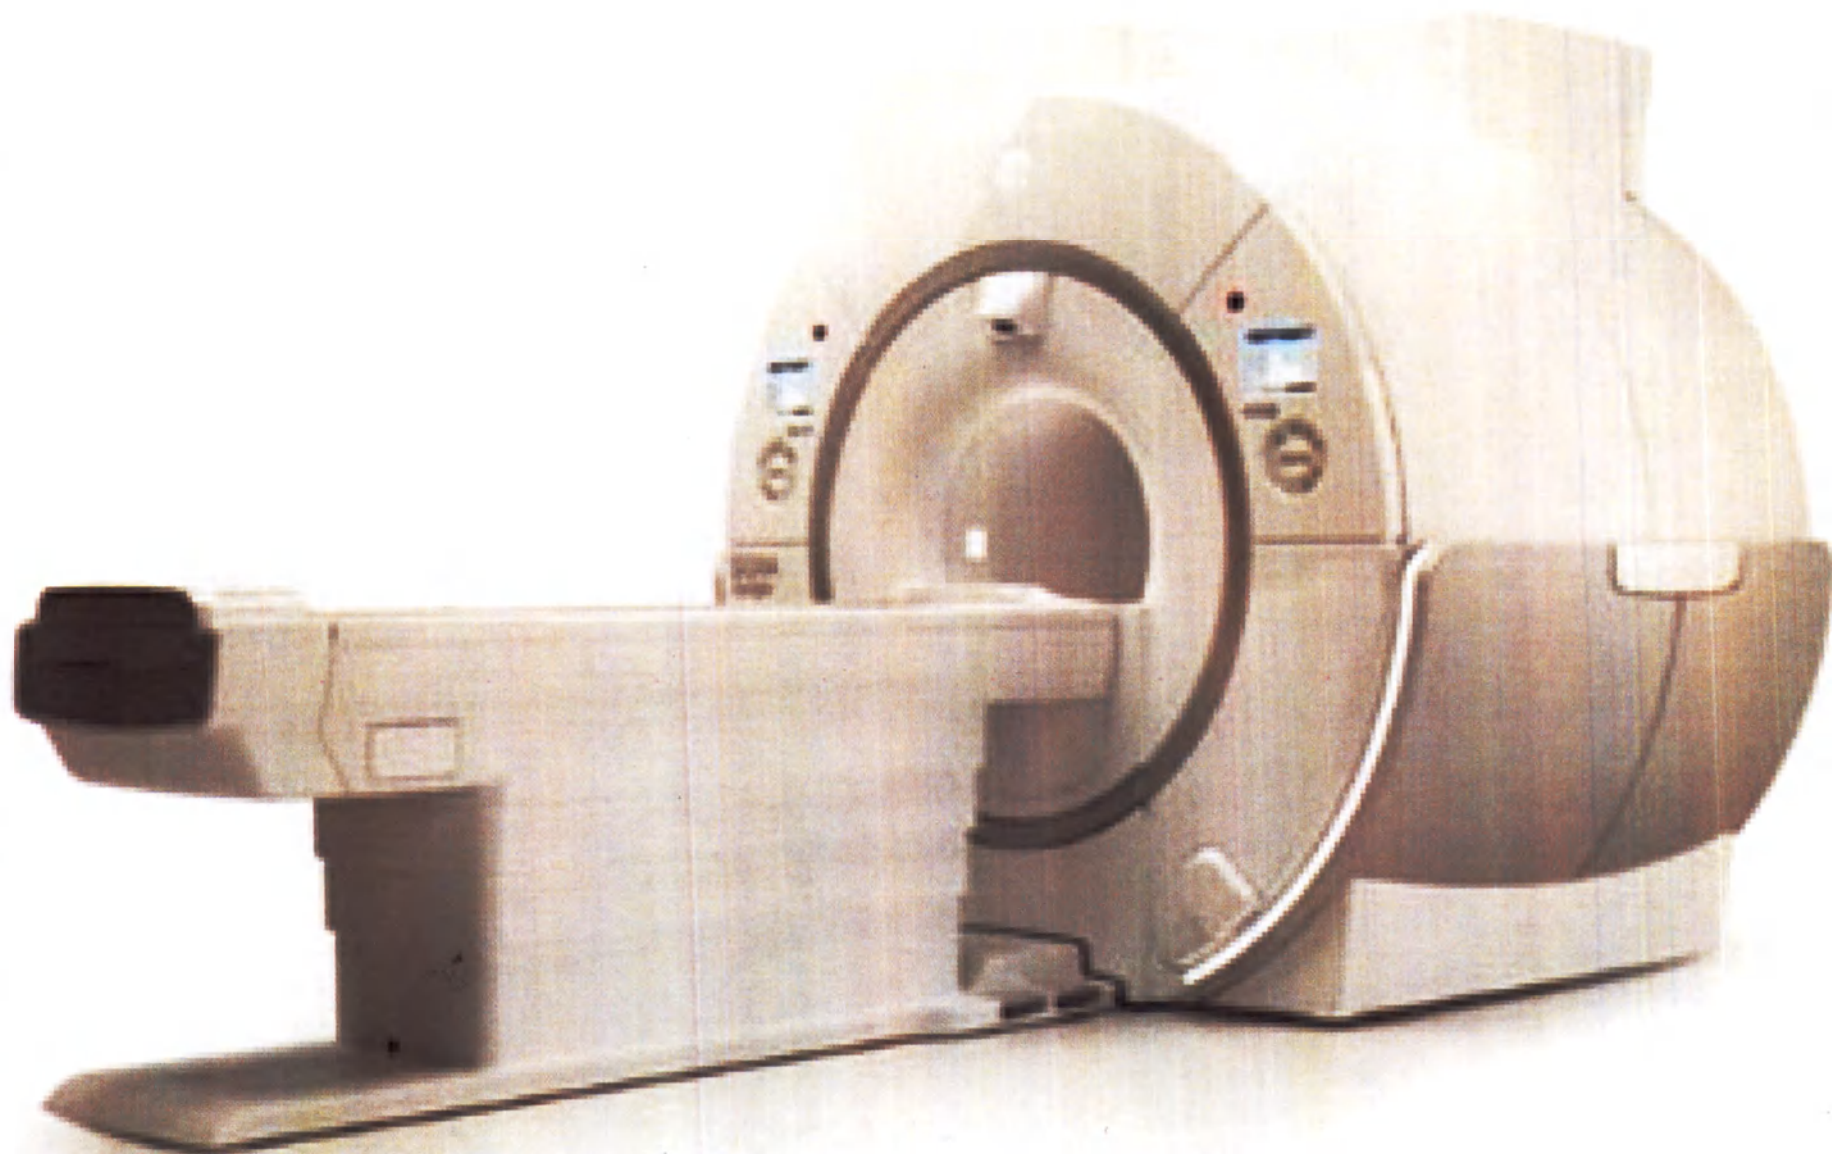


47. Кожухи (не более 50 шт.).




47. Кожухи (не более 50 шт.).

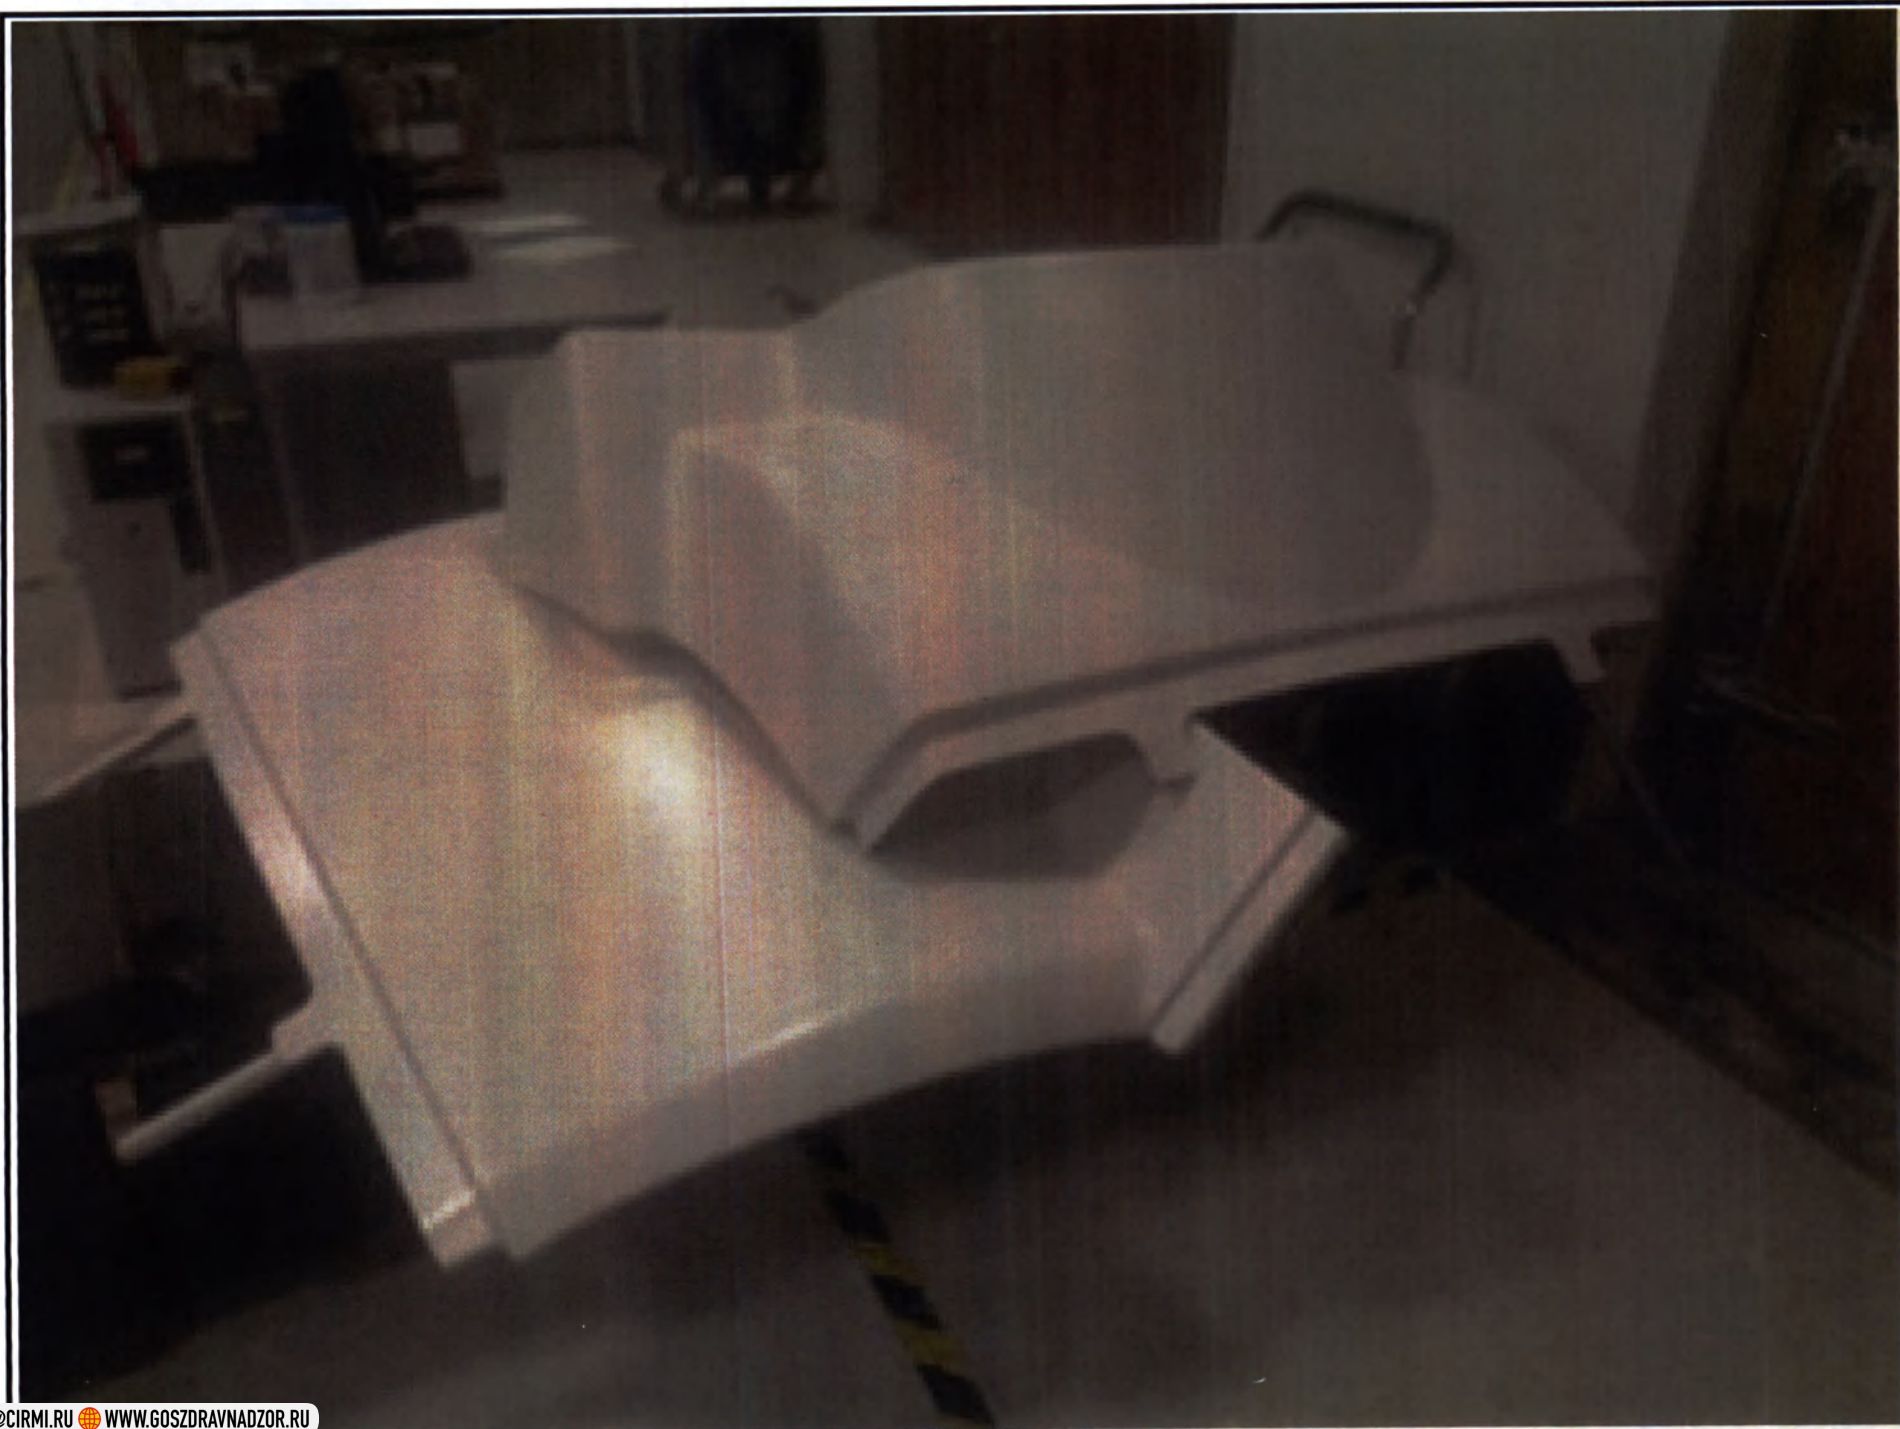

47. Кожухи (не более 50 шт.).

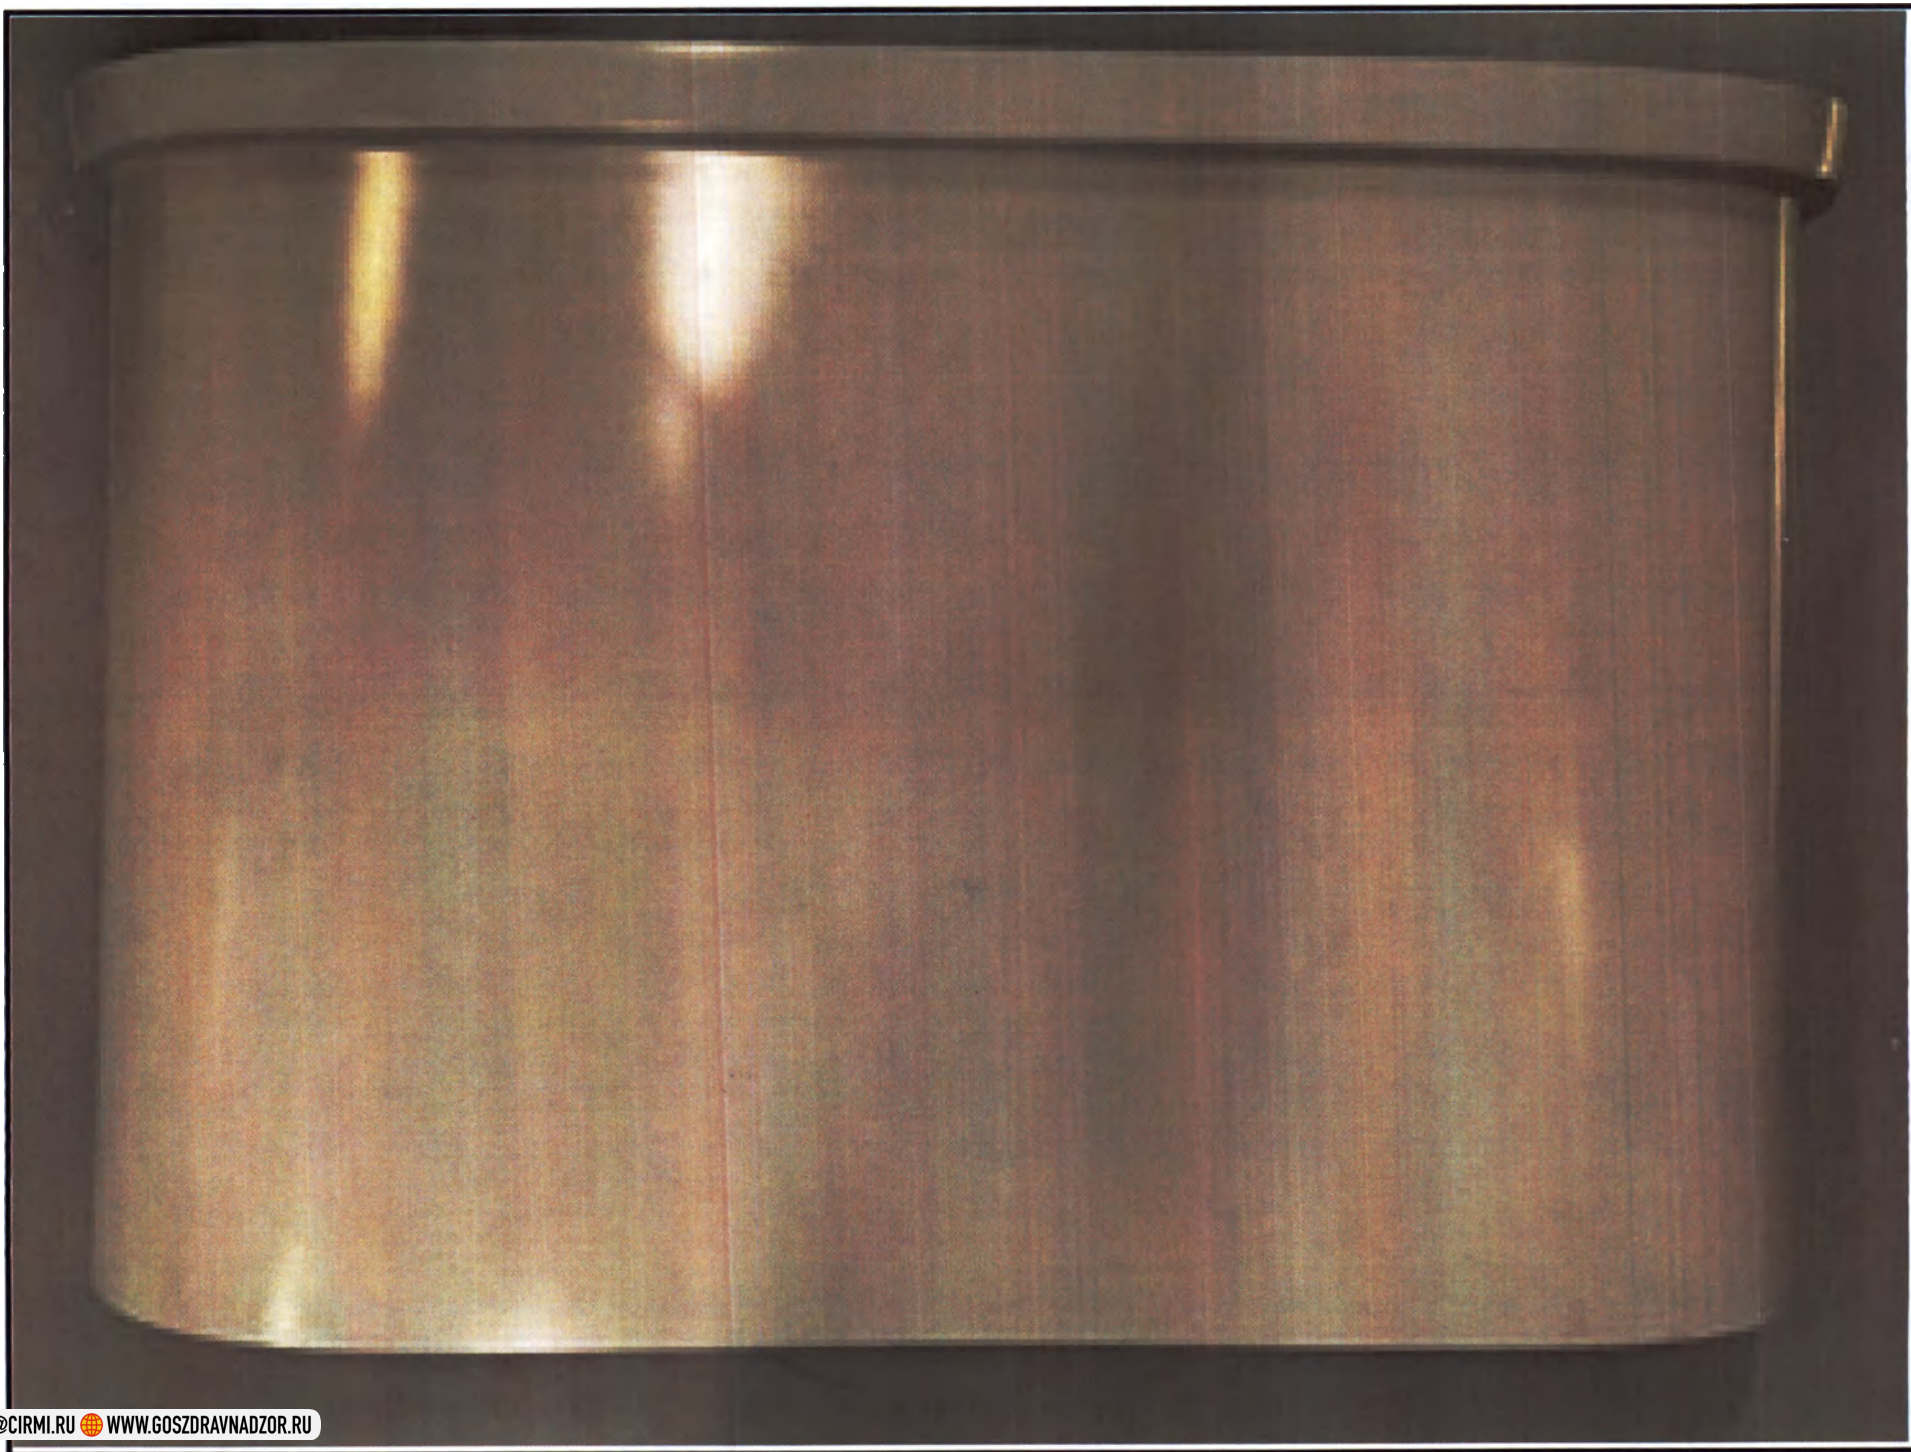

47. Кожухи (не более 50 шт.).

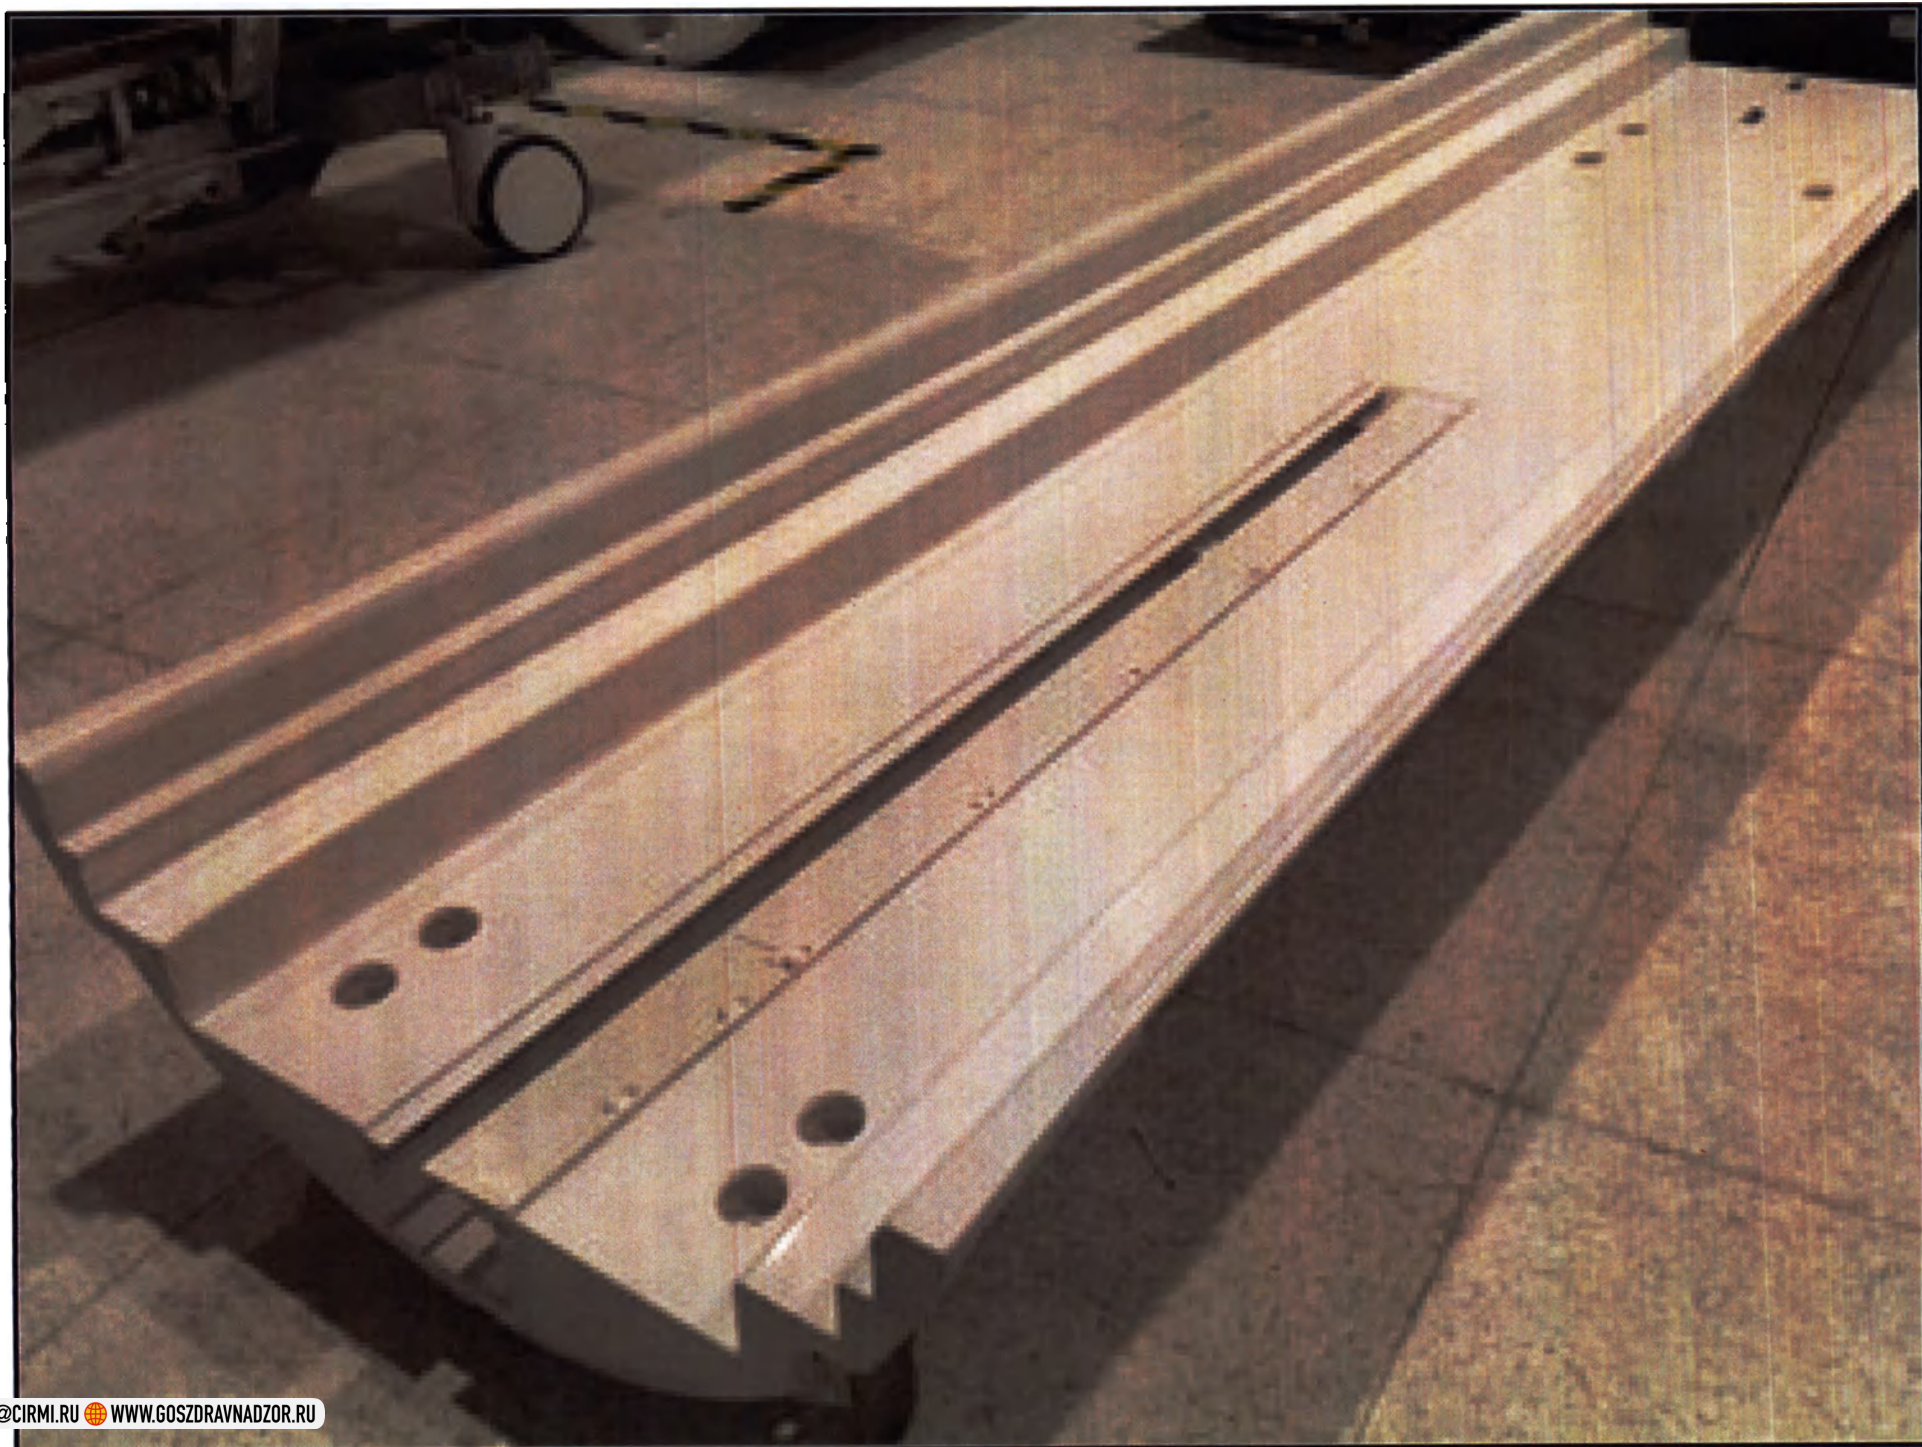

48. МР-совместимый монитор пациента.




48. МР-совместимый монитор пациента.




49. Программные приложения для научных исследований (не более 30 шт.).



49. Программные приложения для научных исследований (не более 30 шт.).

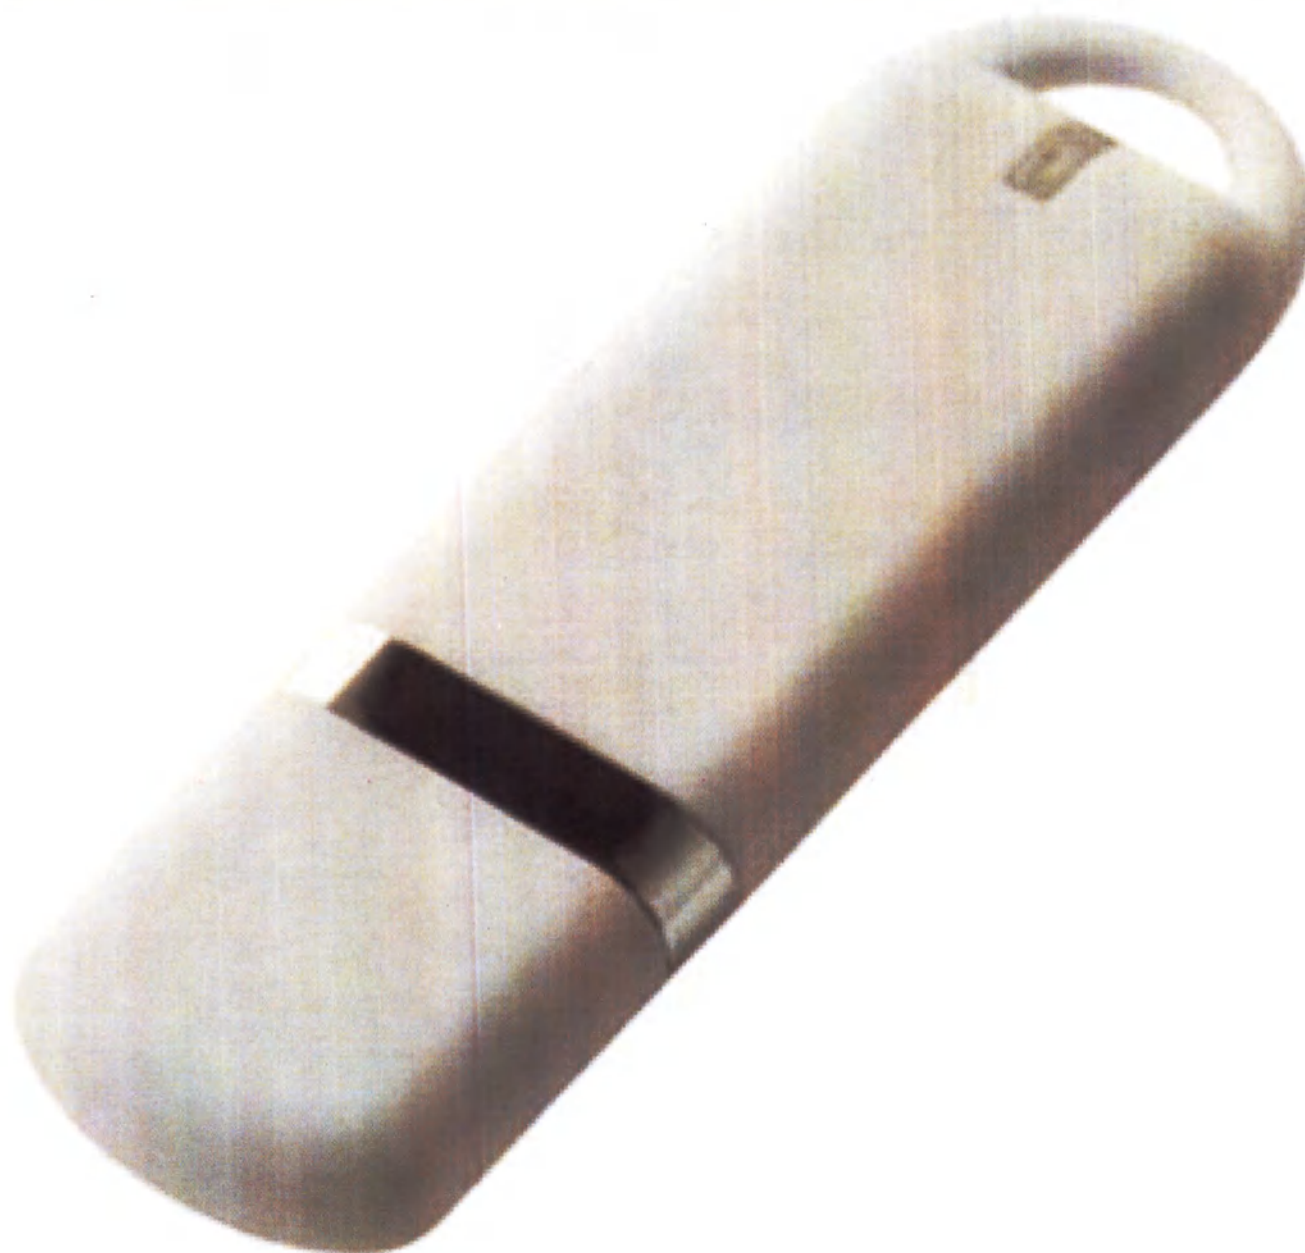

50. Катушки для исследований с технологией AIR (не более 10 шт.).

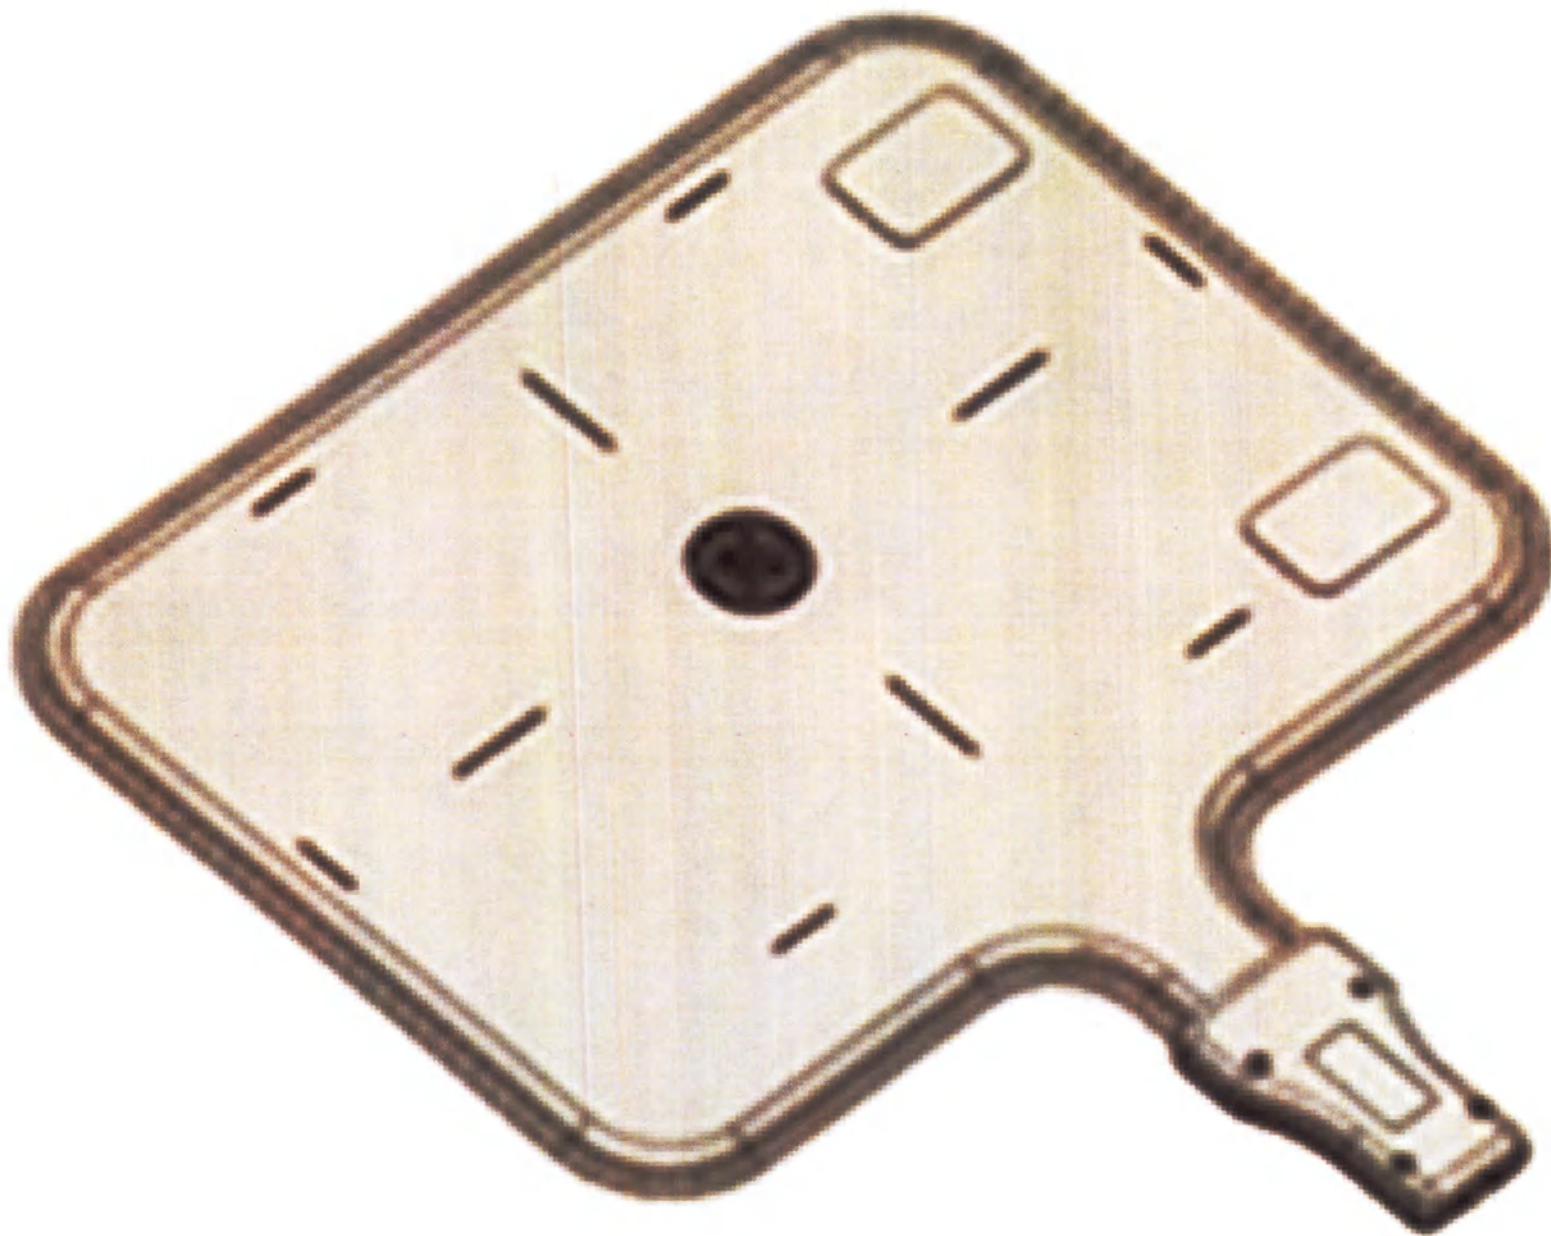

50. Катушки для исследований с технологией AIR (не более 10 шт.).





50. Катушки для исследований с технологией AIR (не более 10 шт.).







50. Катушки для исследований с технологией AIR (не более 10 шт.).



51. Плоская дека для планирования лучевой терапии (не более 5 шт.).

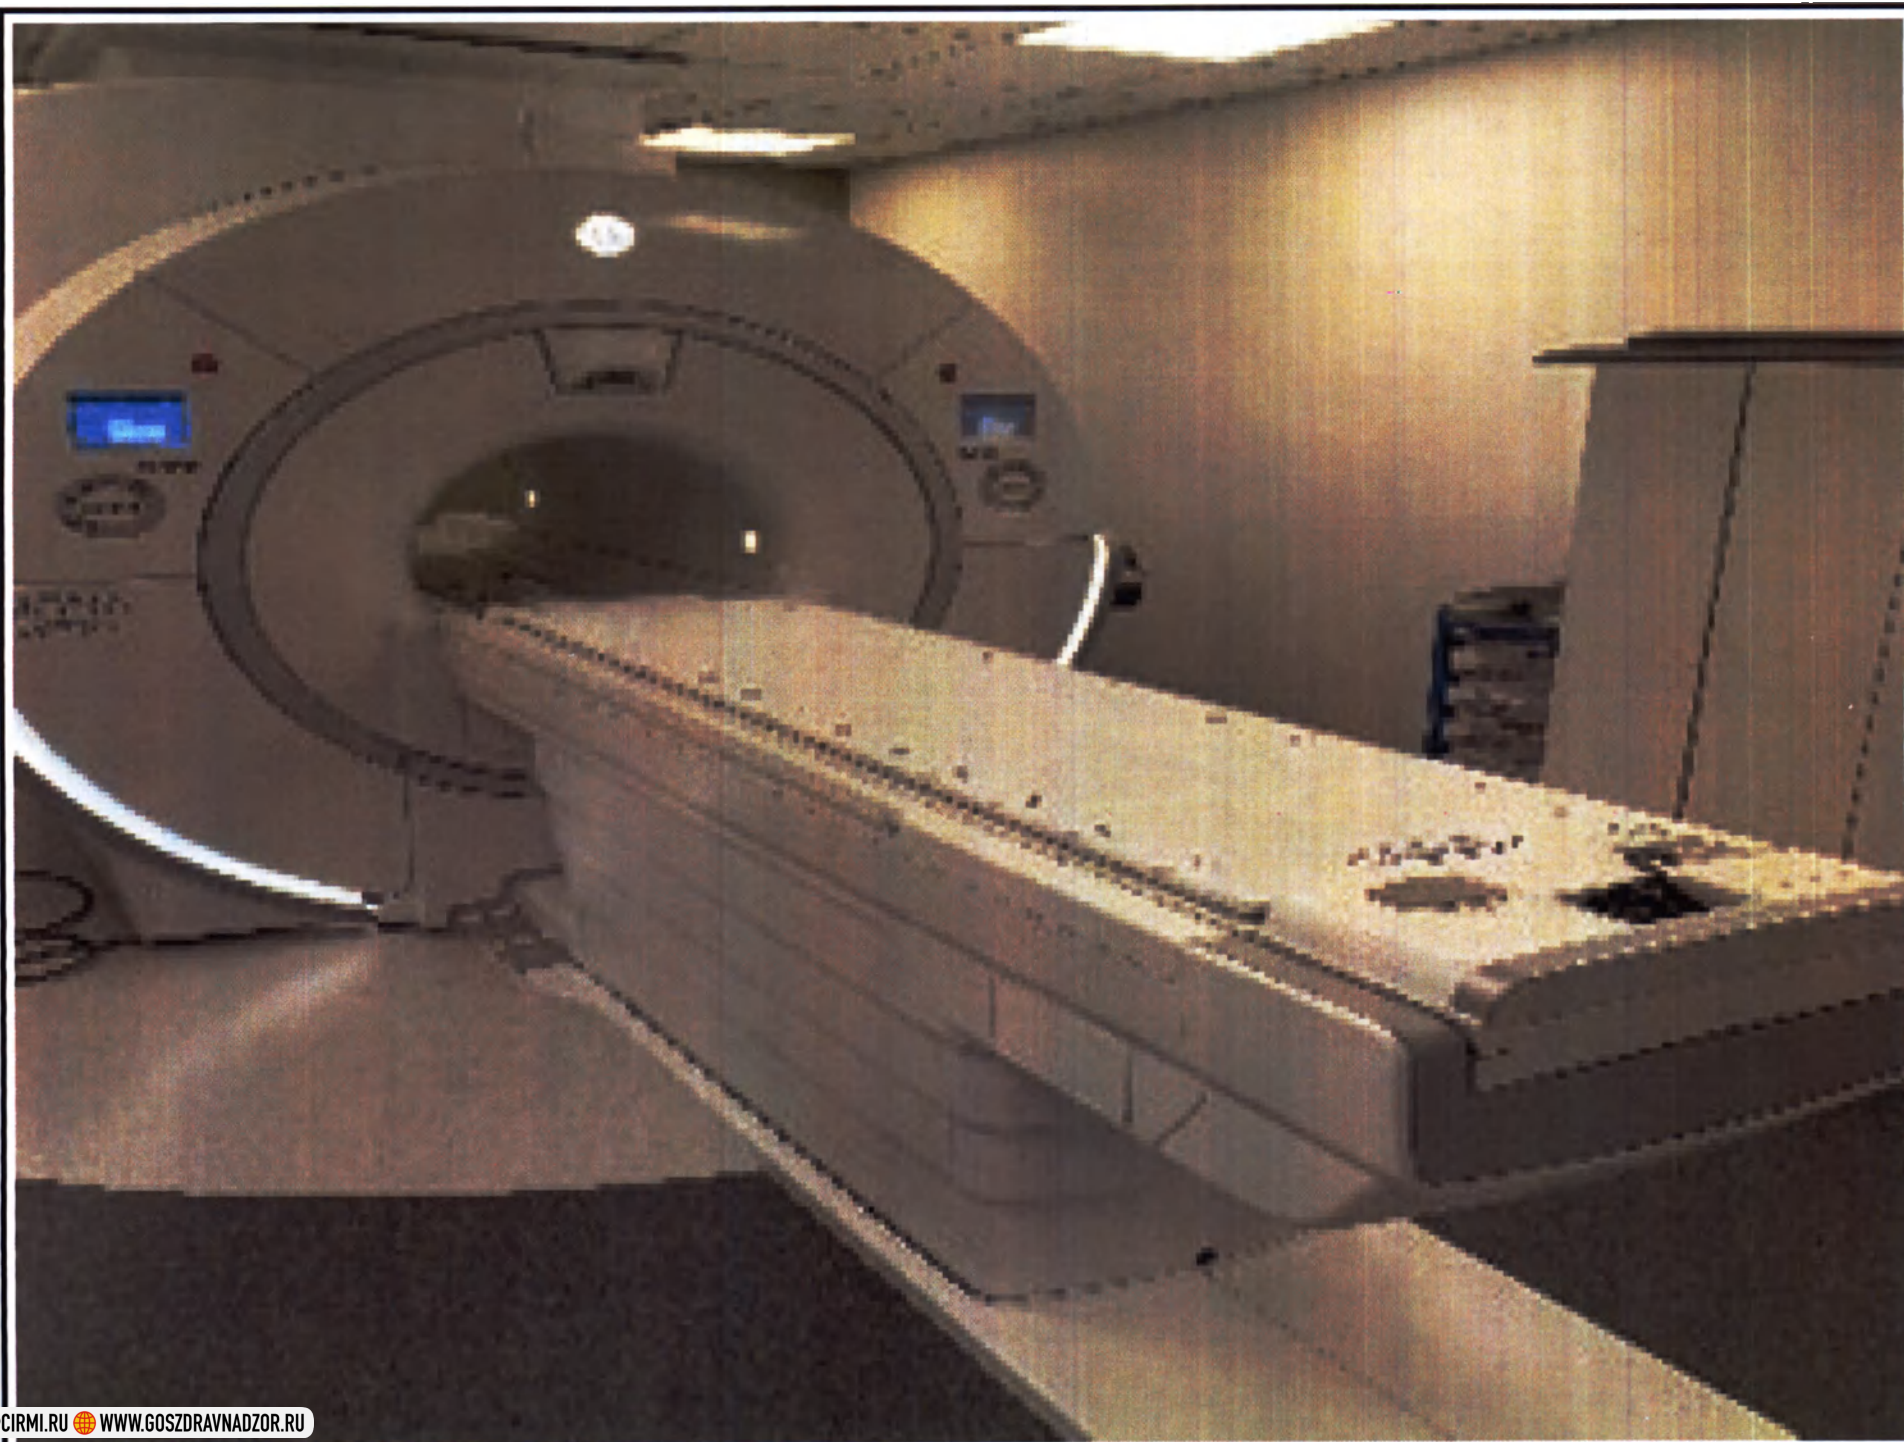


51. Плоская дека для планирования лучевой терапии (не более 5 шт.).

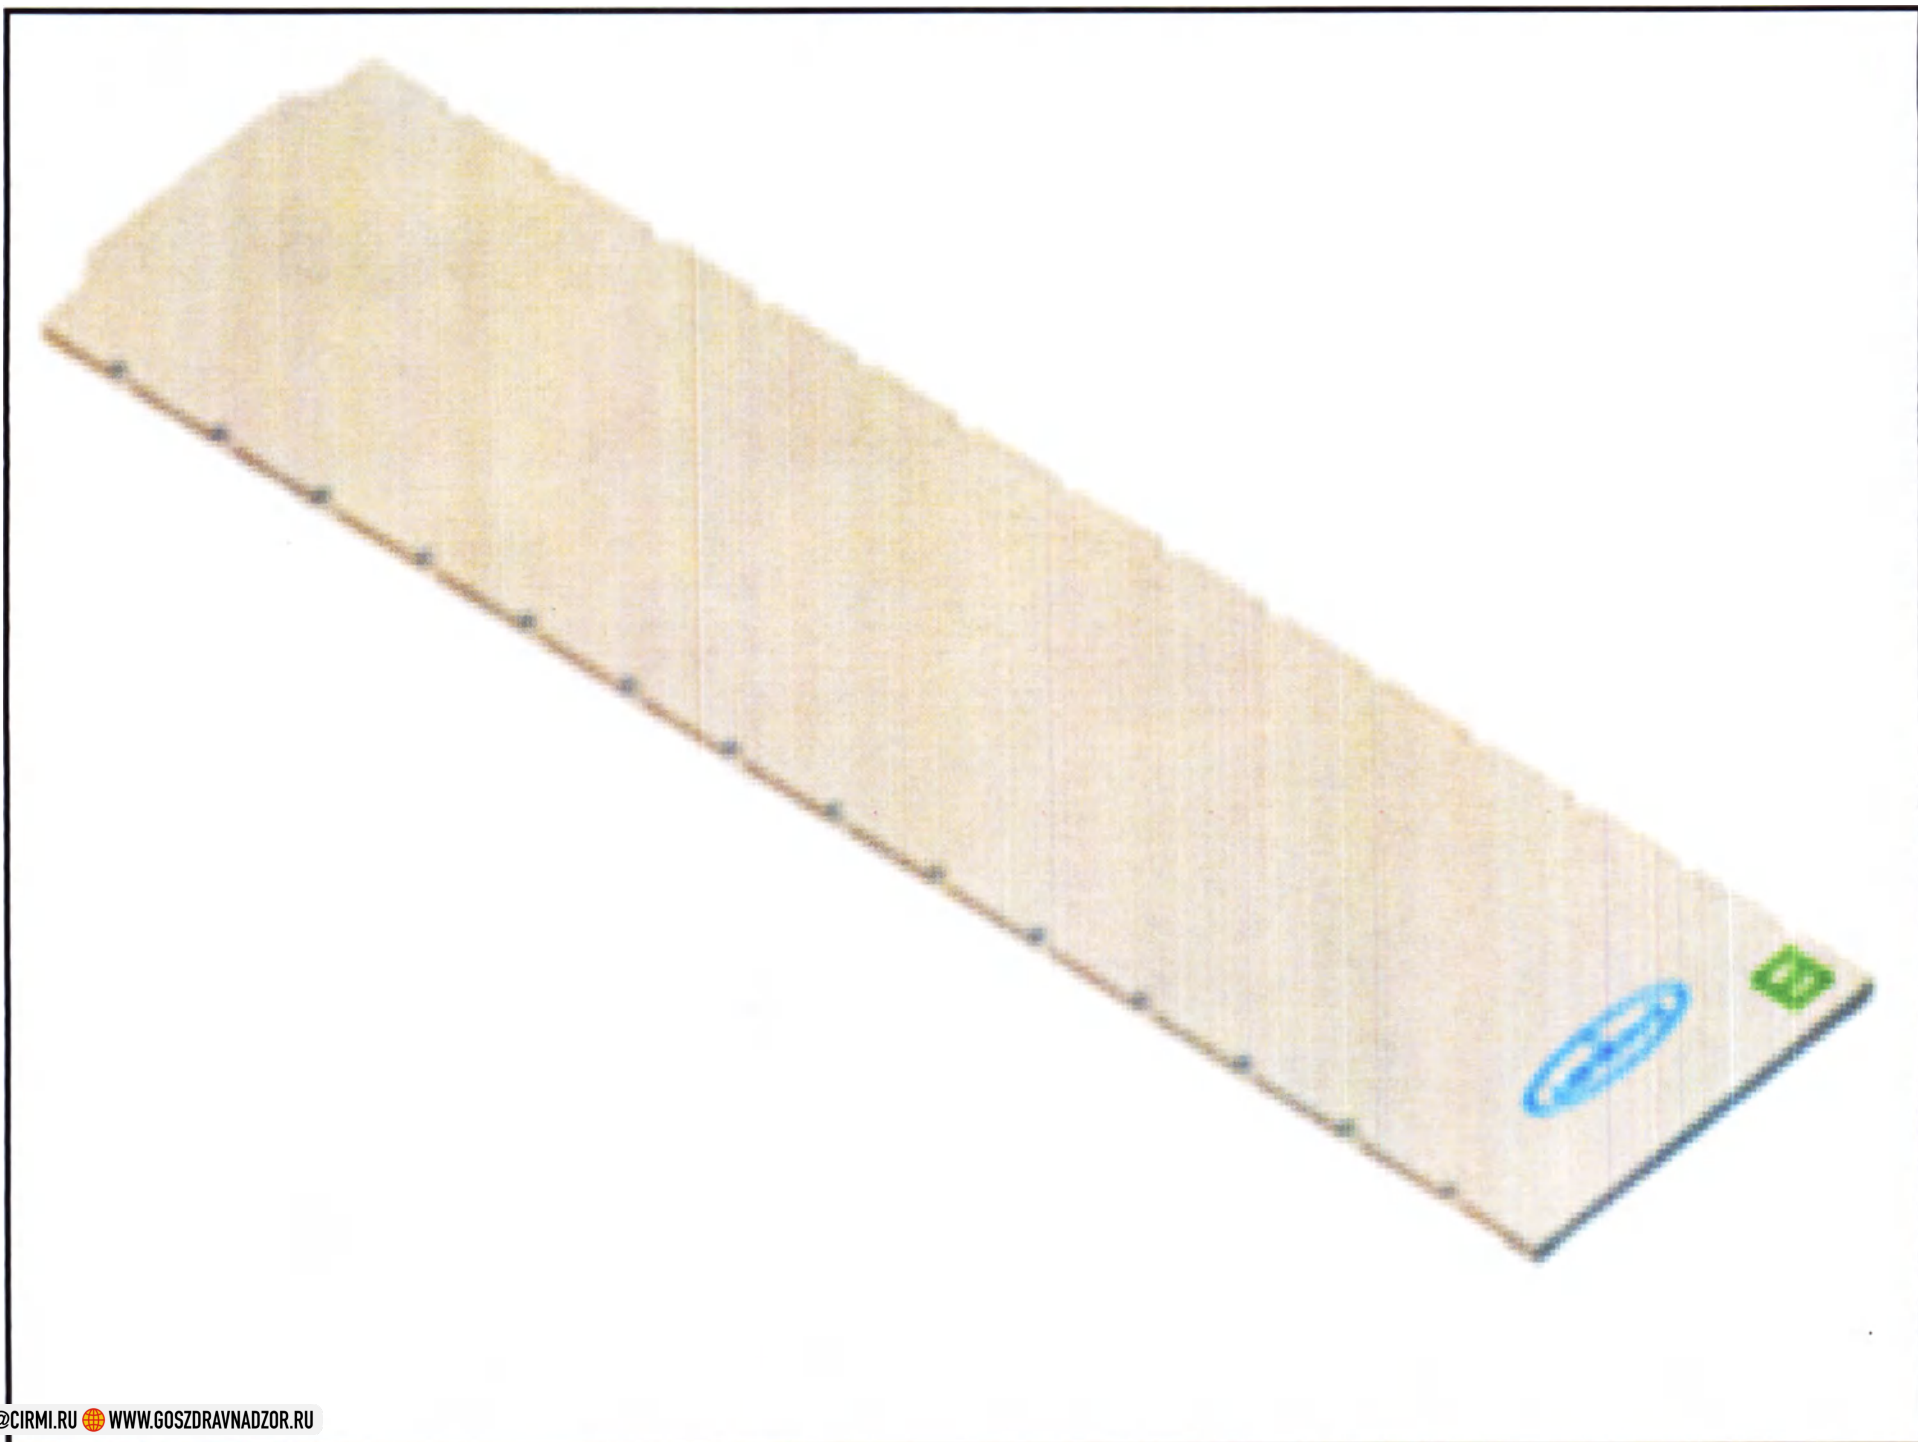

52. Устройства фиксации для стола пациента (не более 50 шт.).



52. Устройства фиксации для стола пациента (не более 50 шт.).

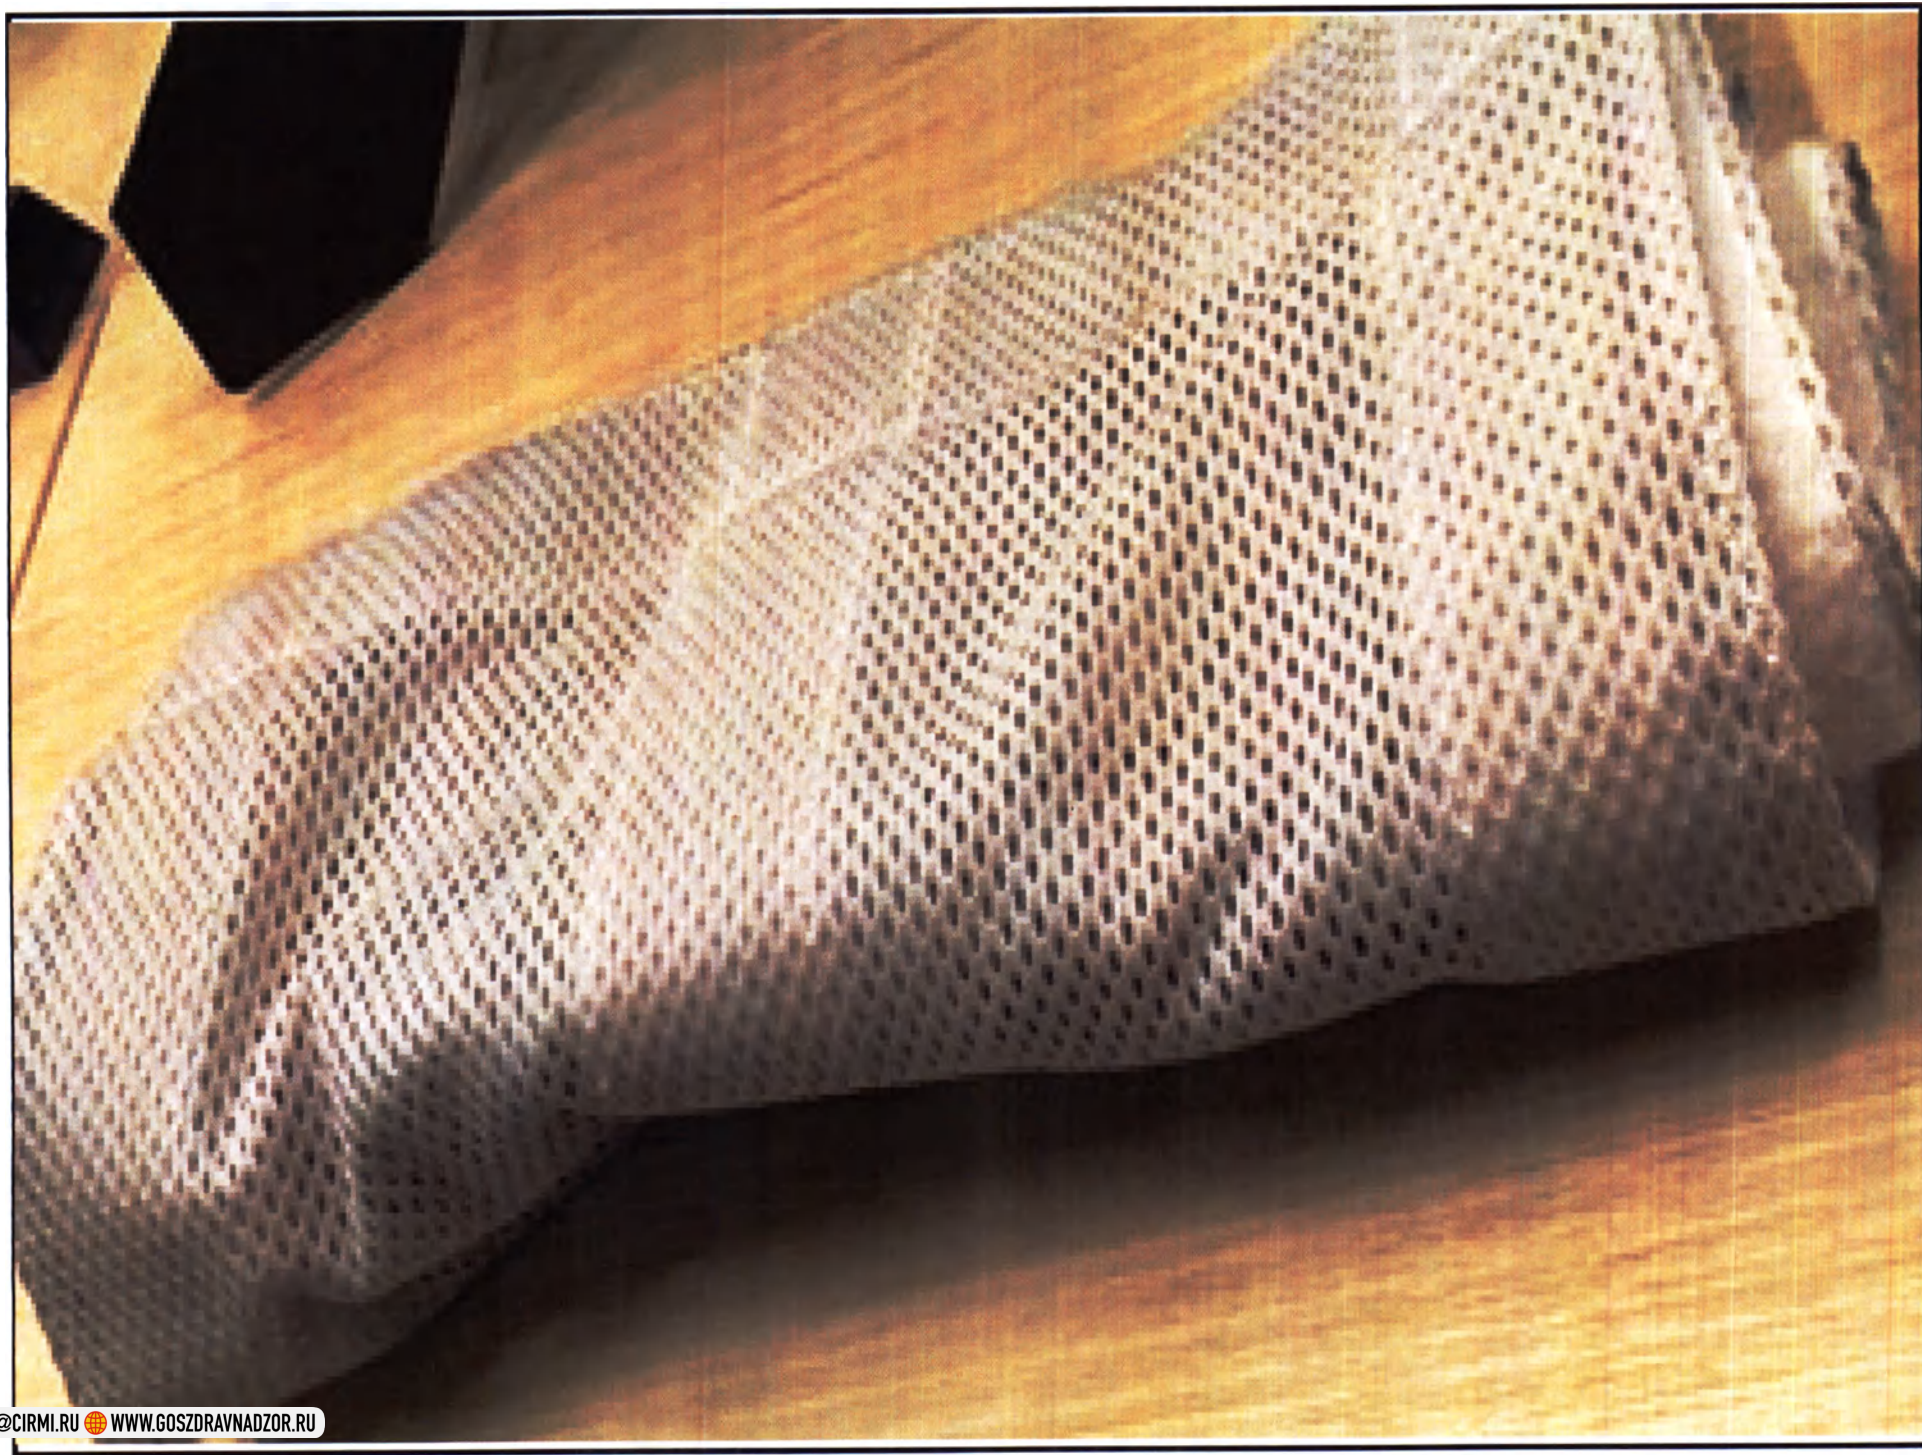

52. Устройства фиксации для стопы пациента (не более 50 шт.).



52. Устройства фиксации для стола пациента (не более 50 шт.).



52. Устройства фиксации для стола пациента (не более 50 шт.).




53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).



53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

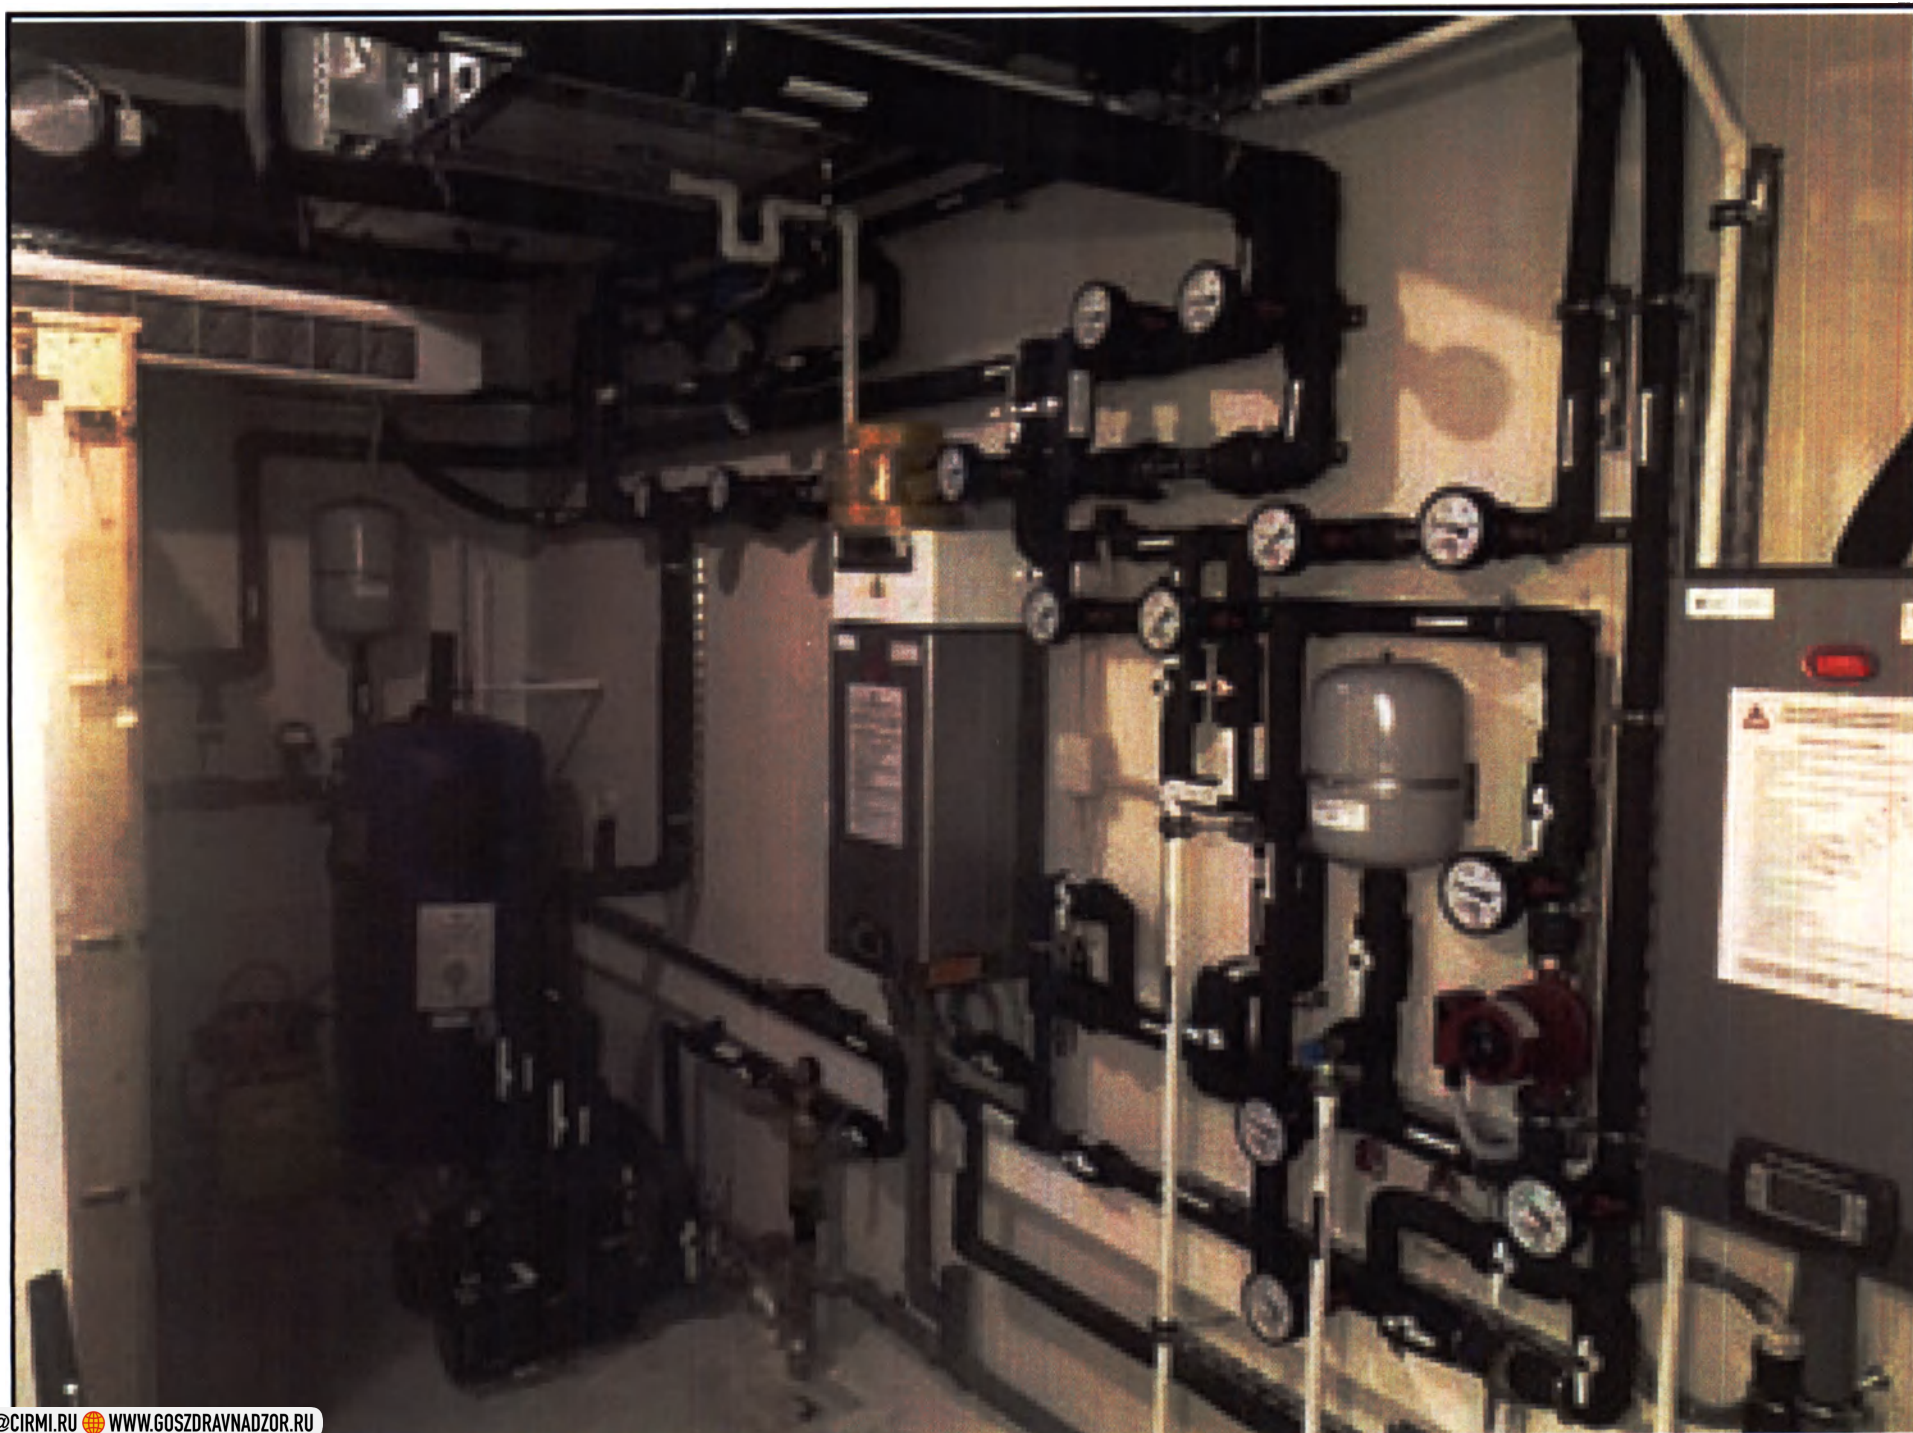


53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).




53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).




53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

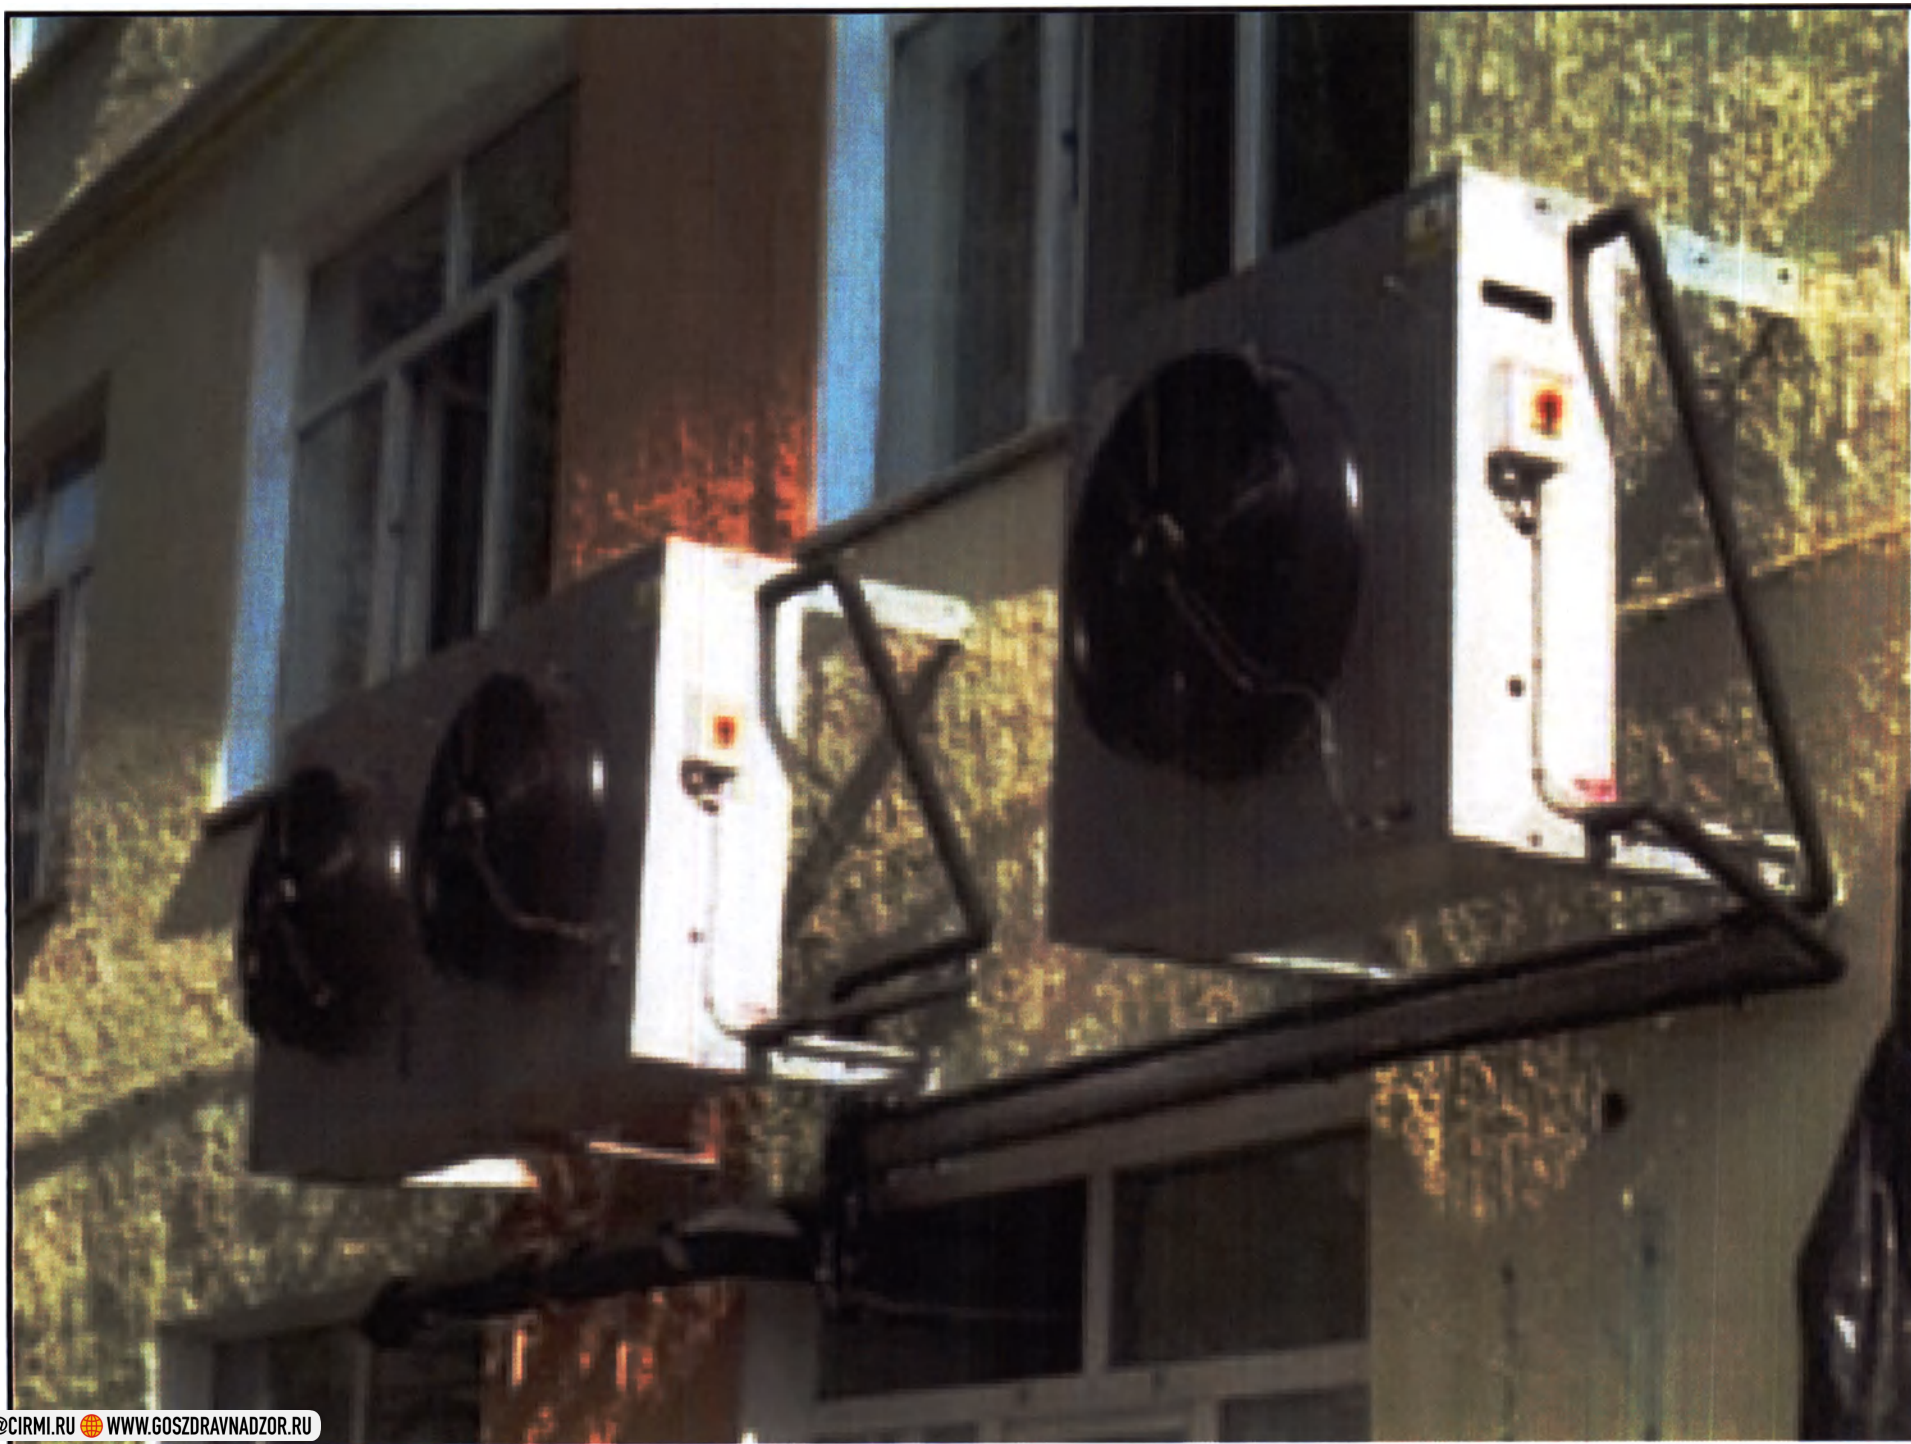

53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

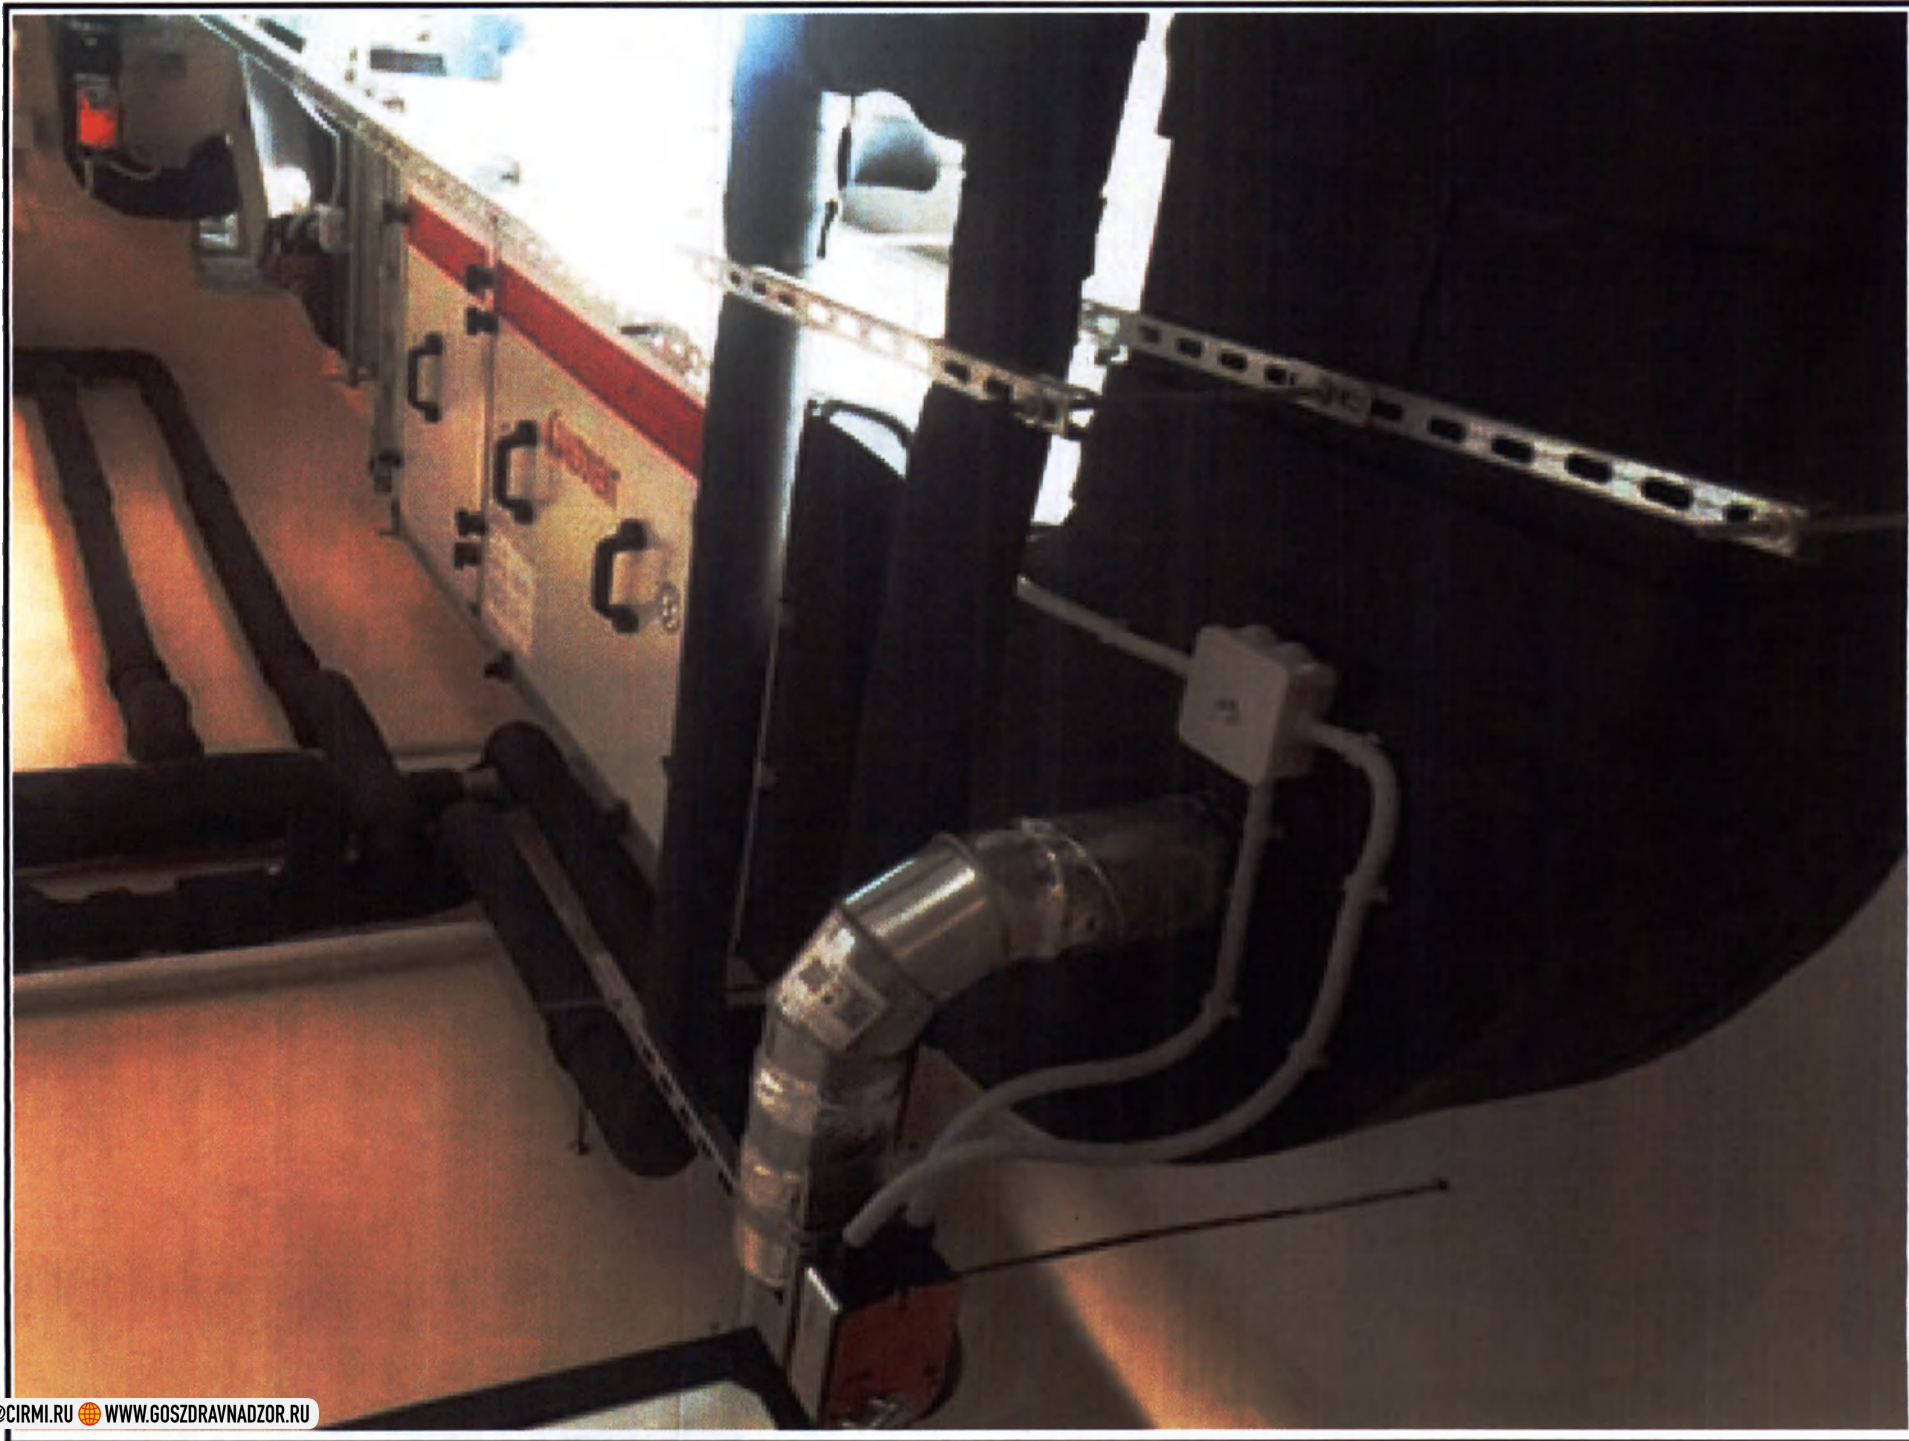


53. Система охлаждения компонентов МР томографа и рециркуляции воздуха в процедурной комнате (не более 20 шт.).

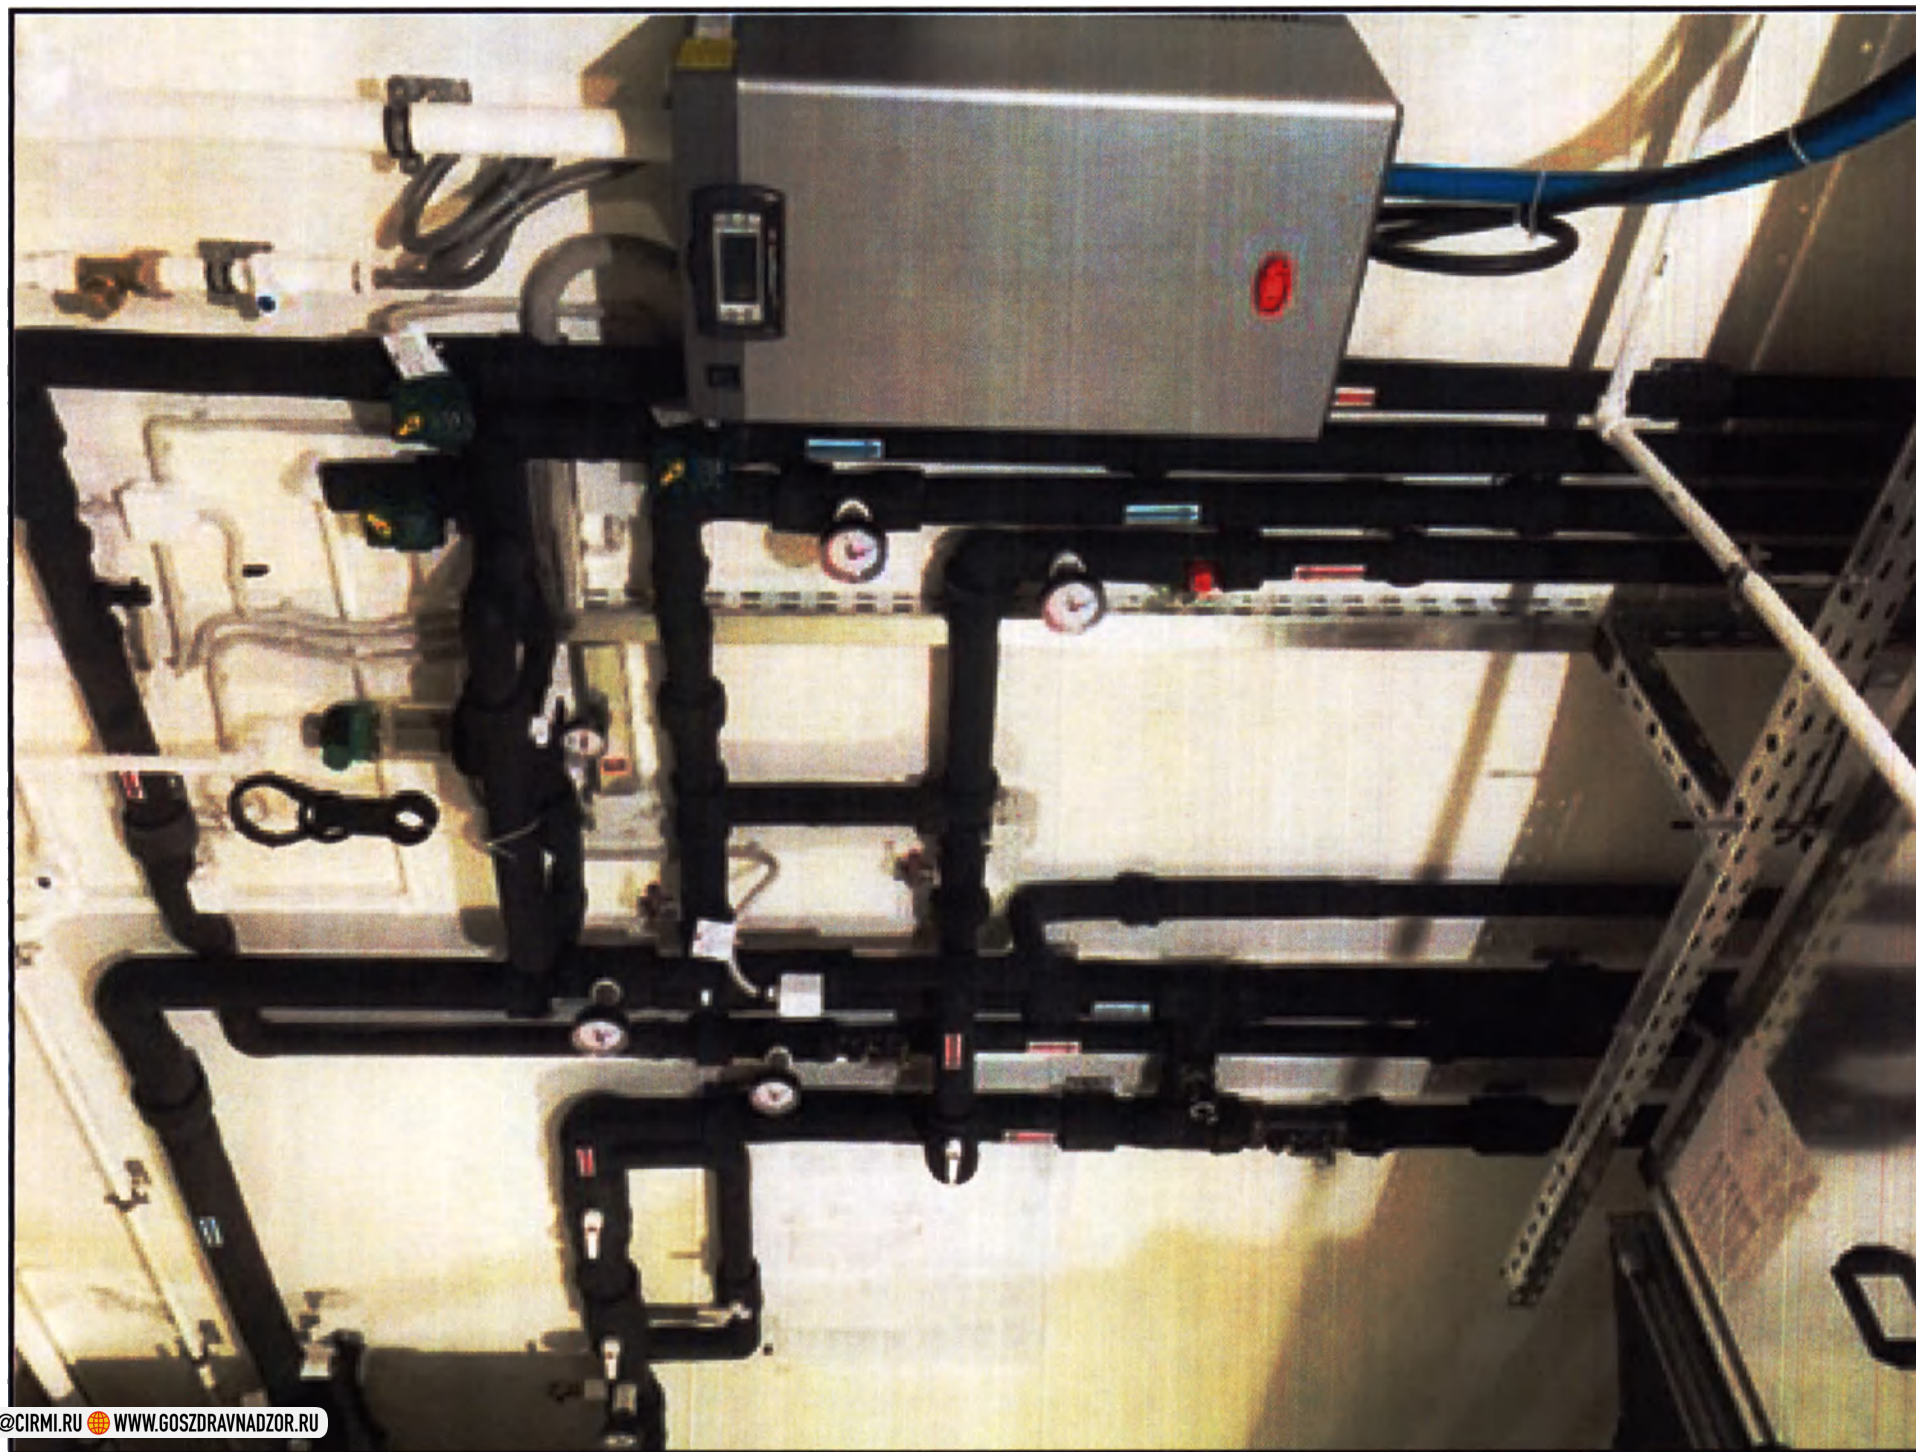


54. Устройства для контроля получения физиологических данных (не более 20 шт.).




54. Устройства для контроллера получения физиологических данных (не более 20 шт.).

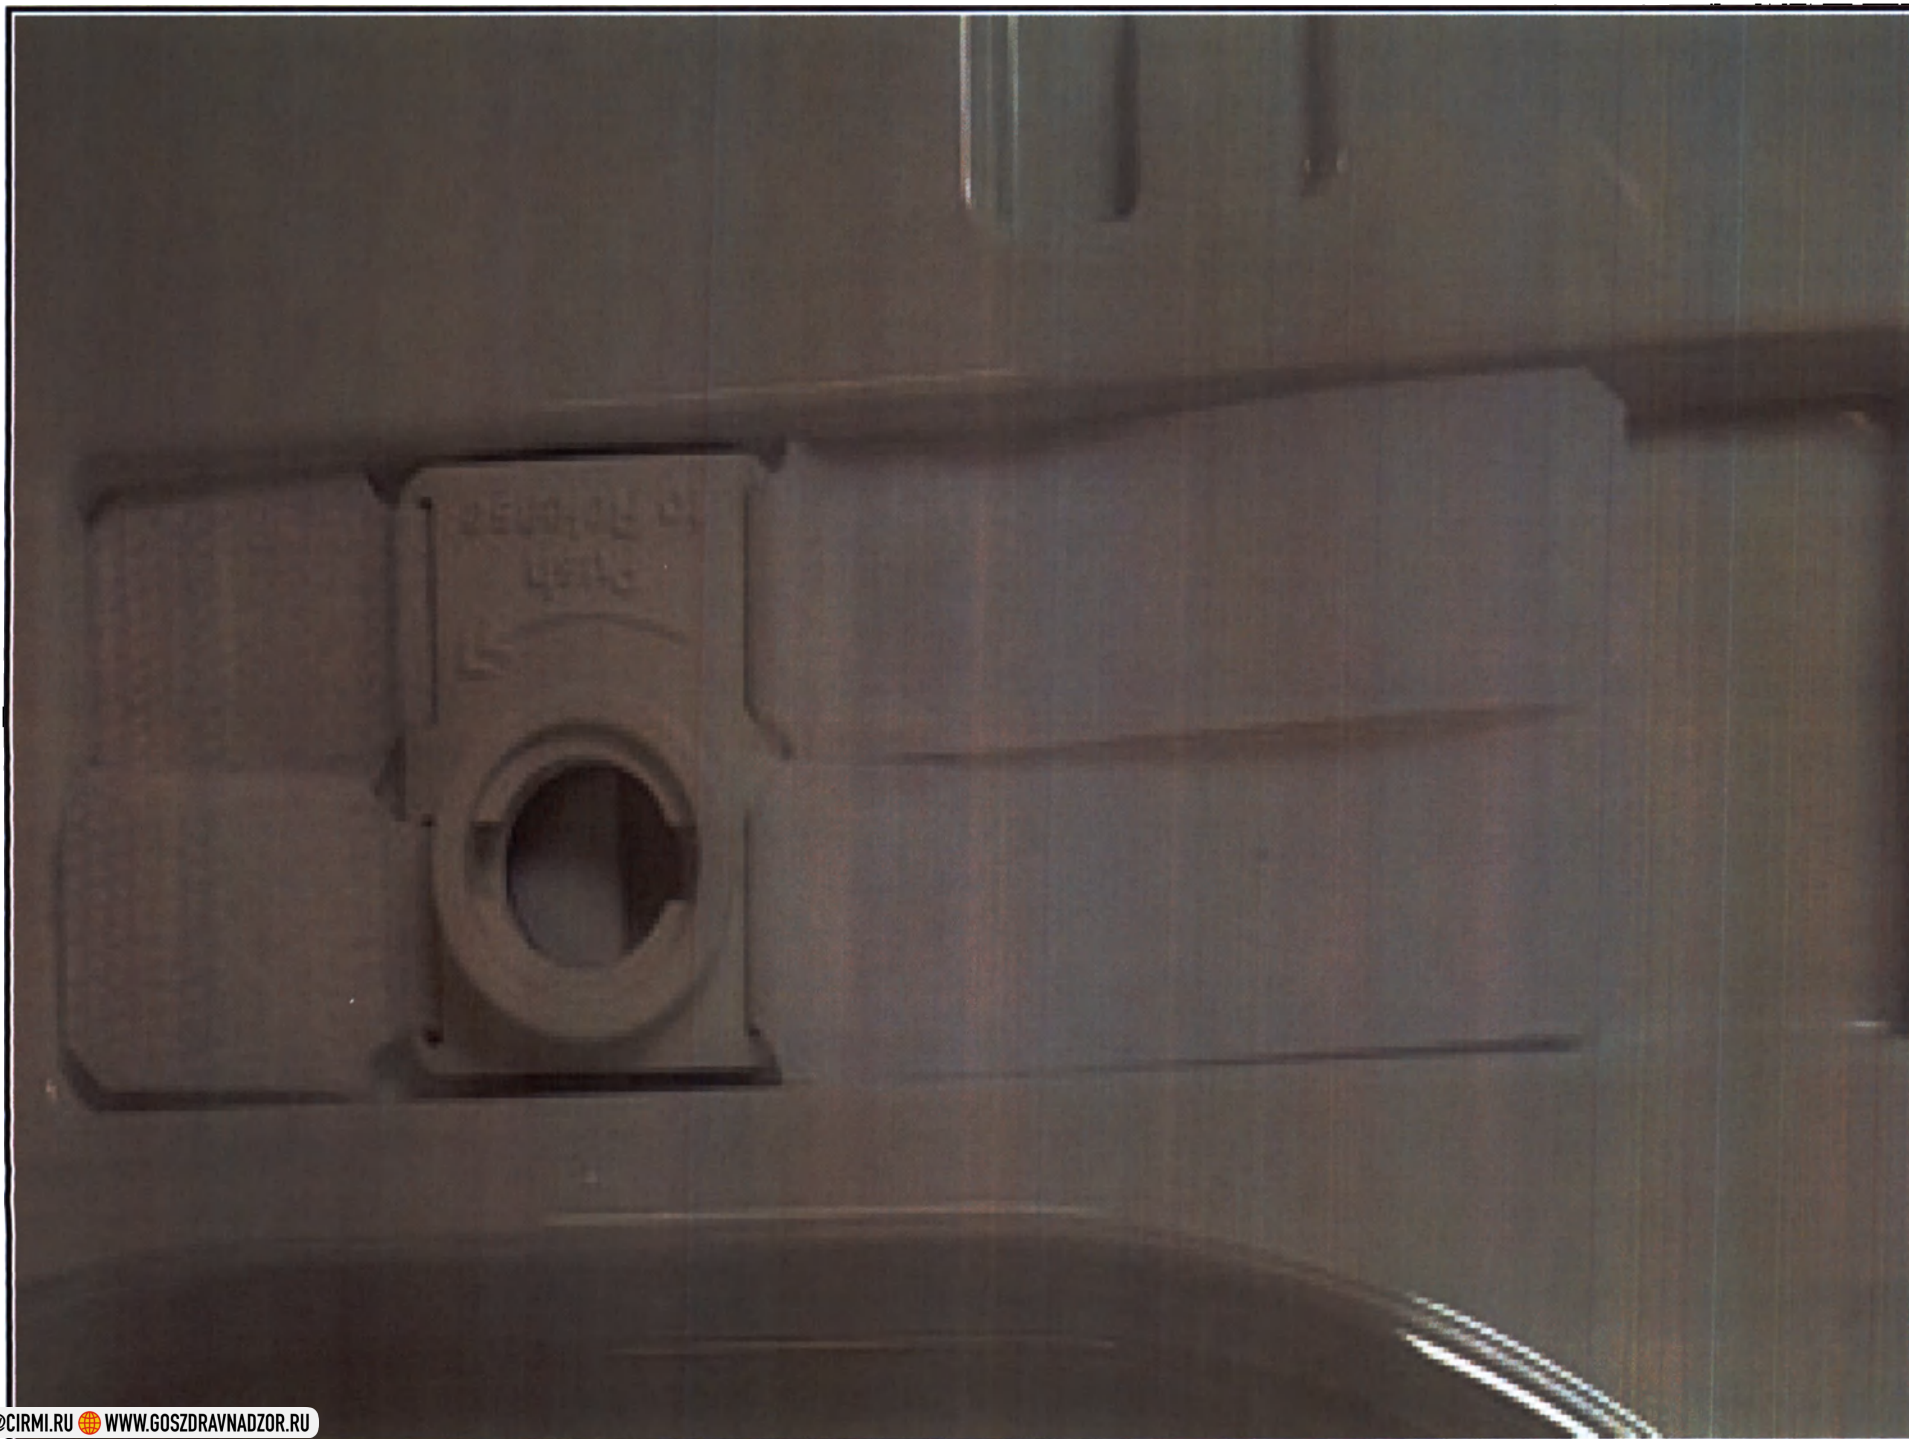


54. Устройства для контроля получения физиологических данных (не более 20 шт.).

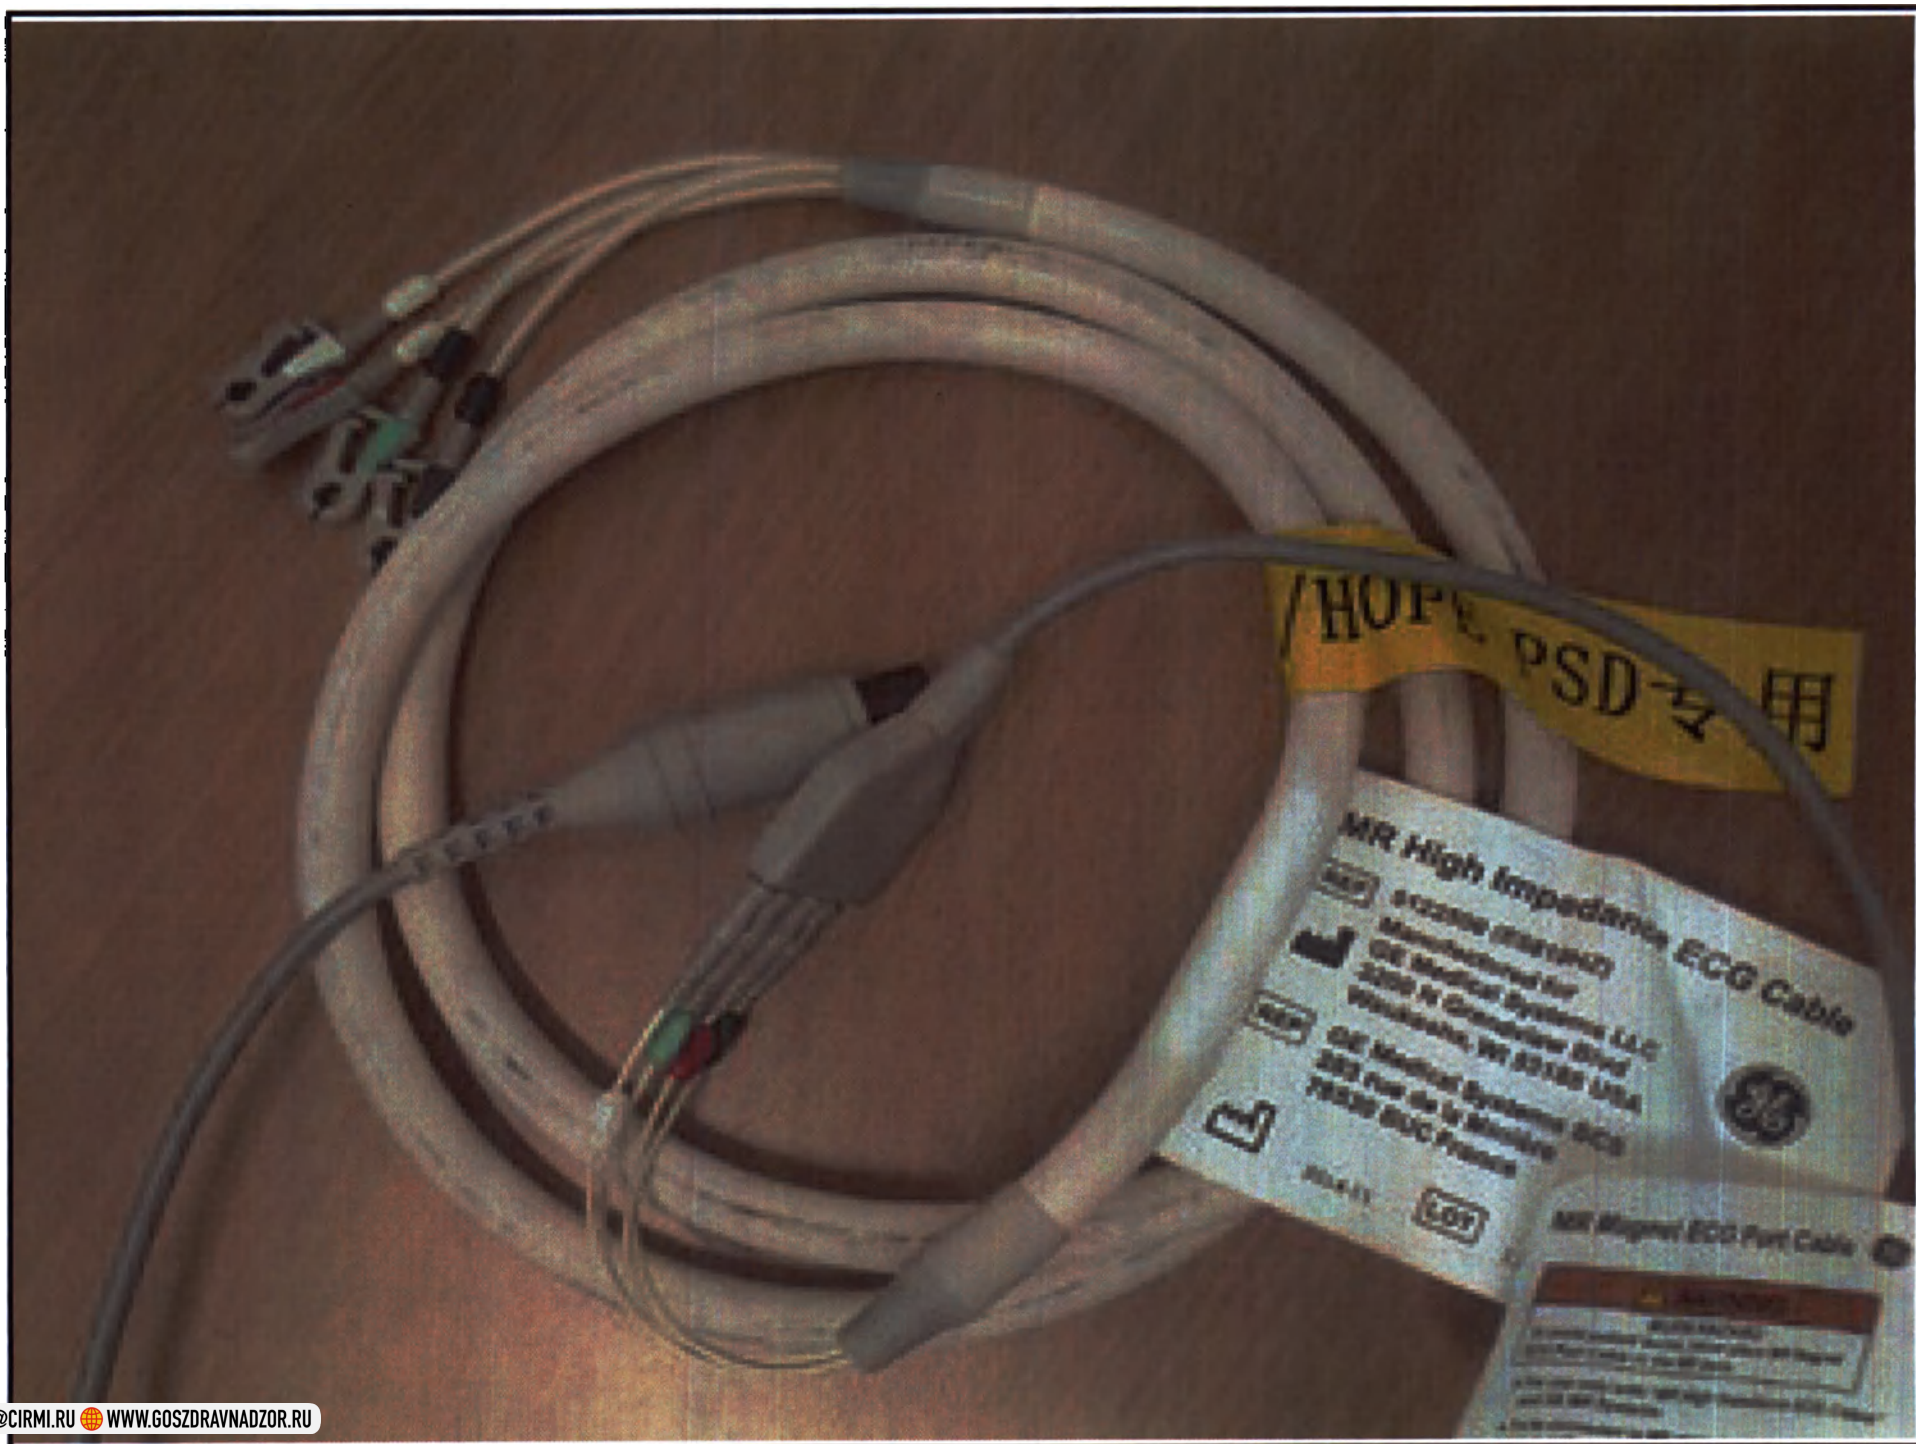

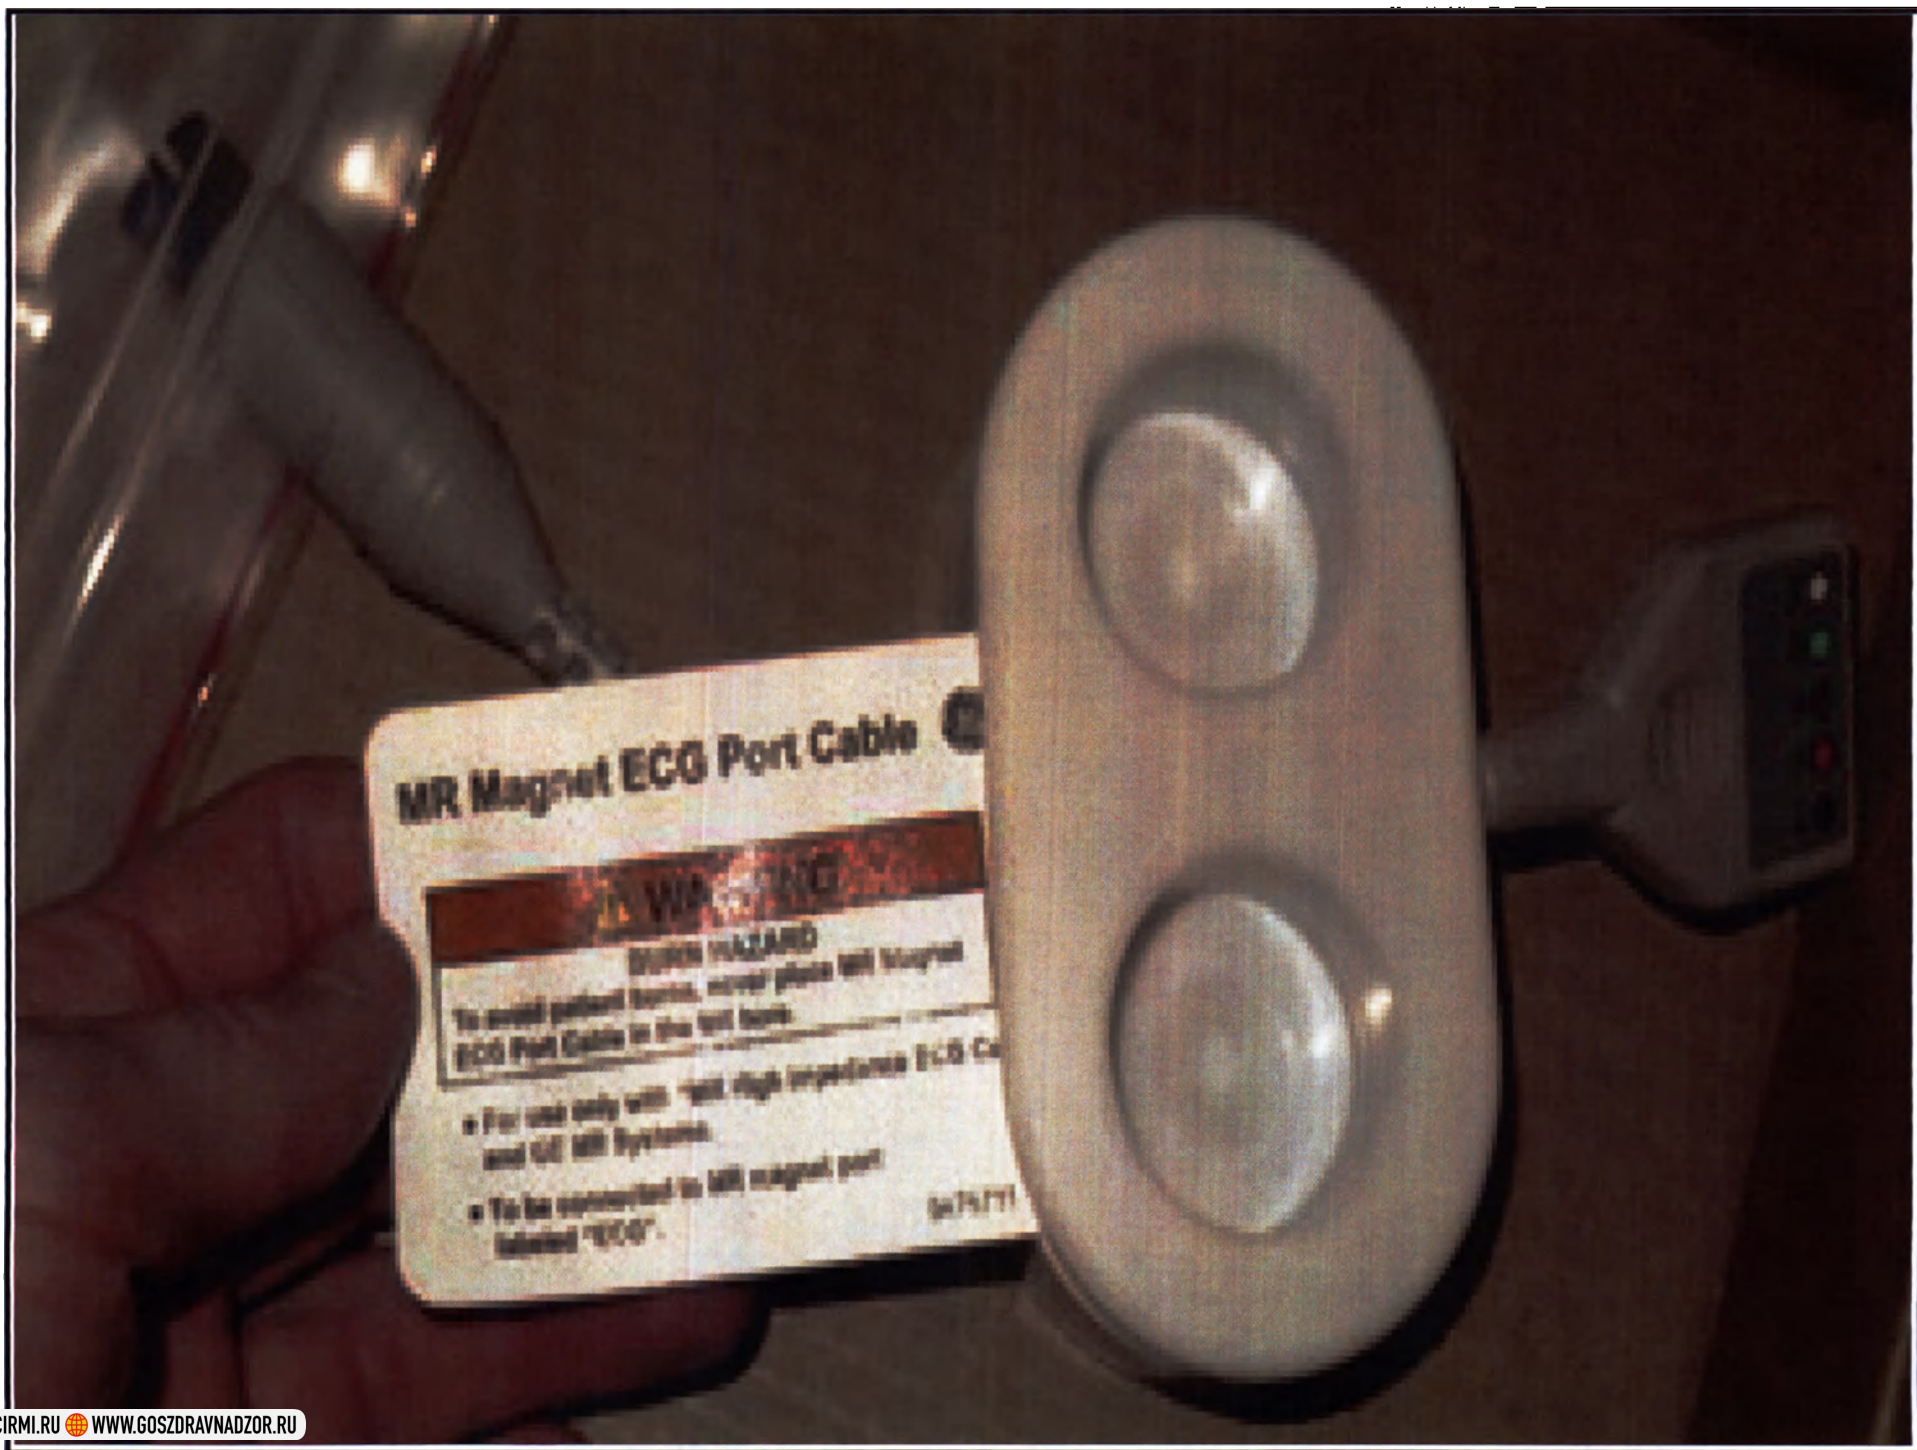


55. Периферийные устройства (не более 10 шт.).

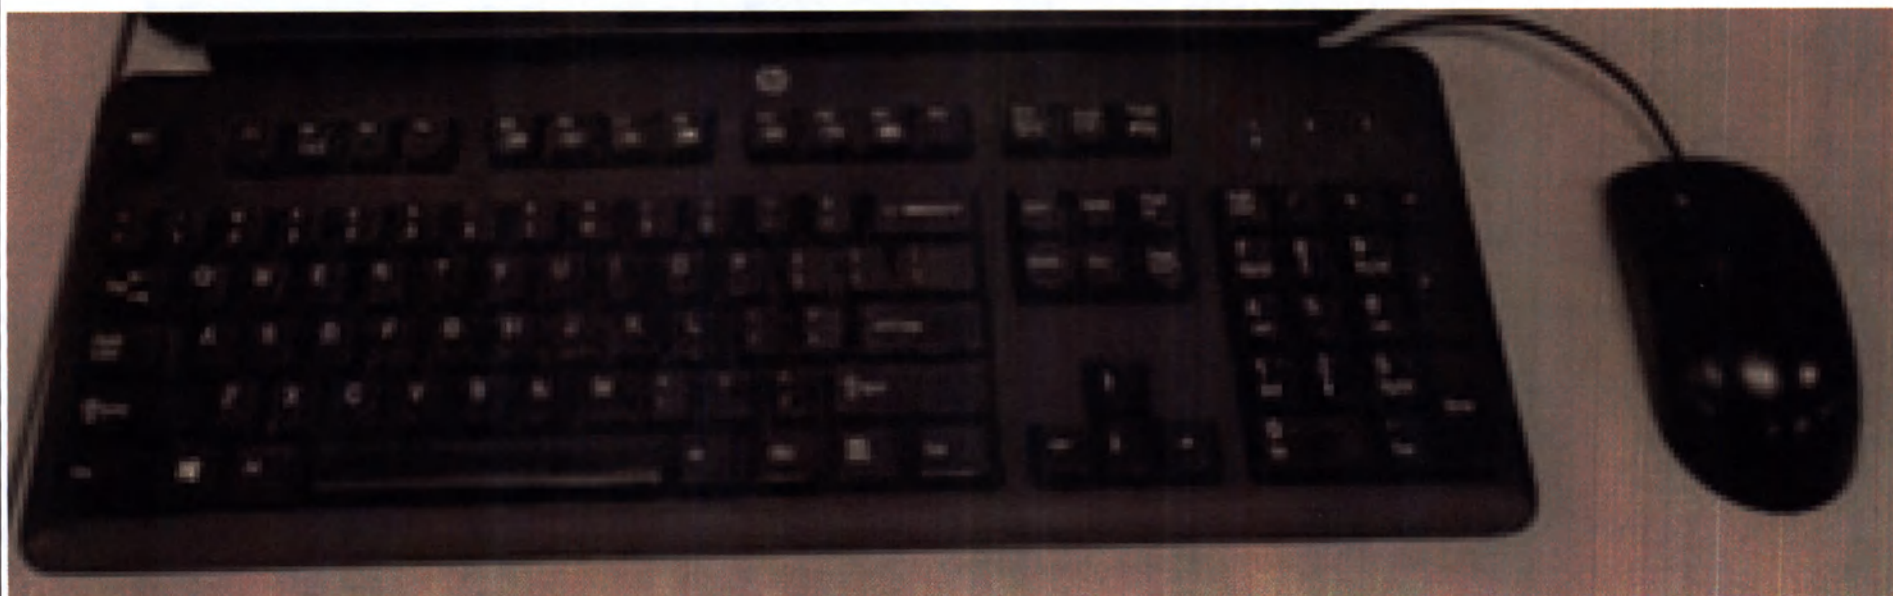


55. Периферийные устройства (не более 10 шт.).




55. Периферийные устройства (не более 10 шт.).

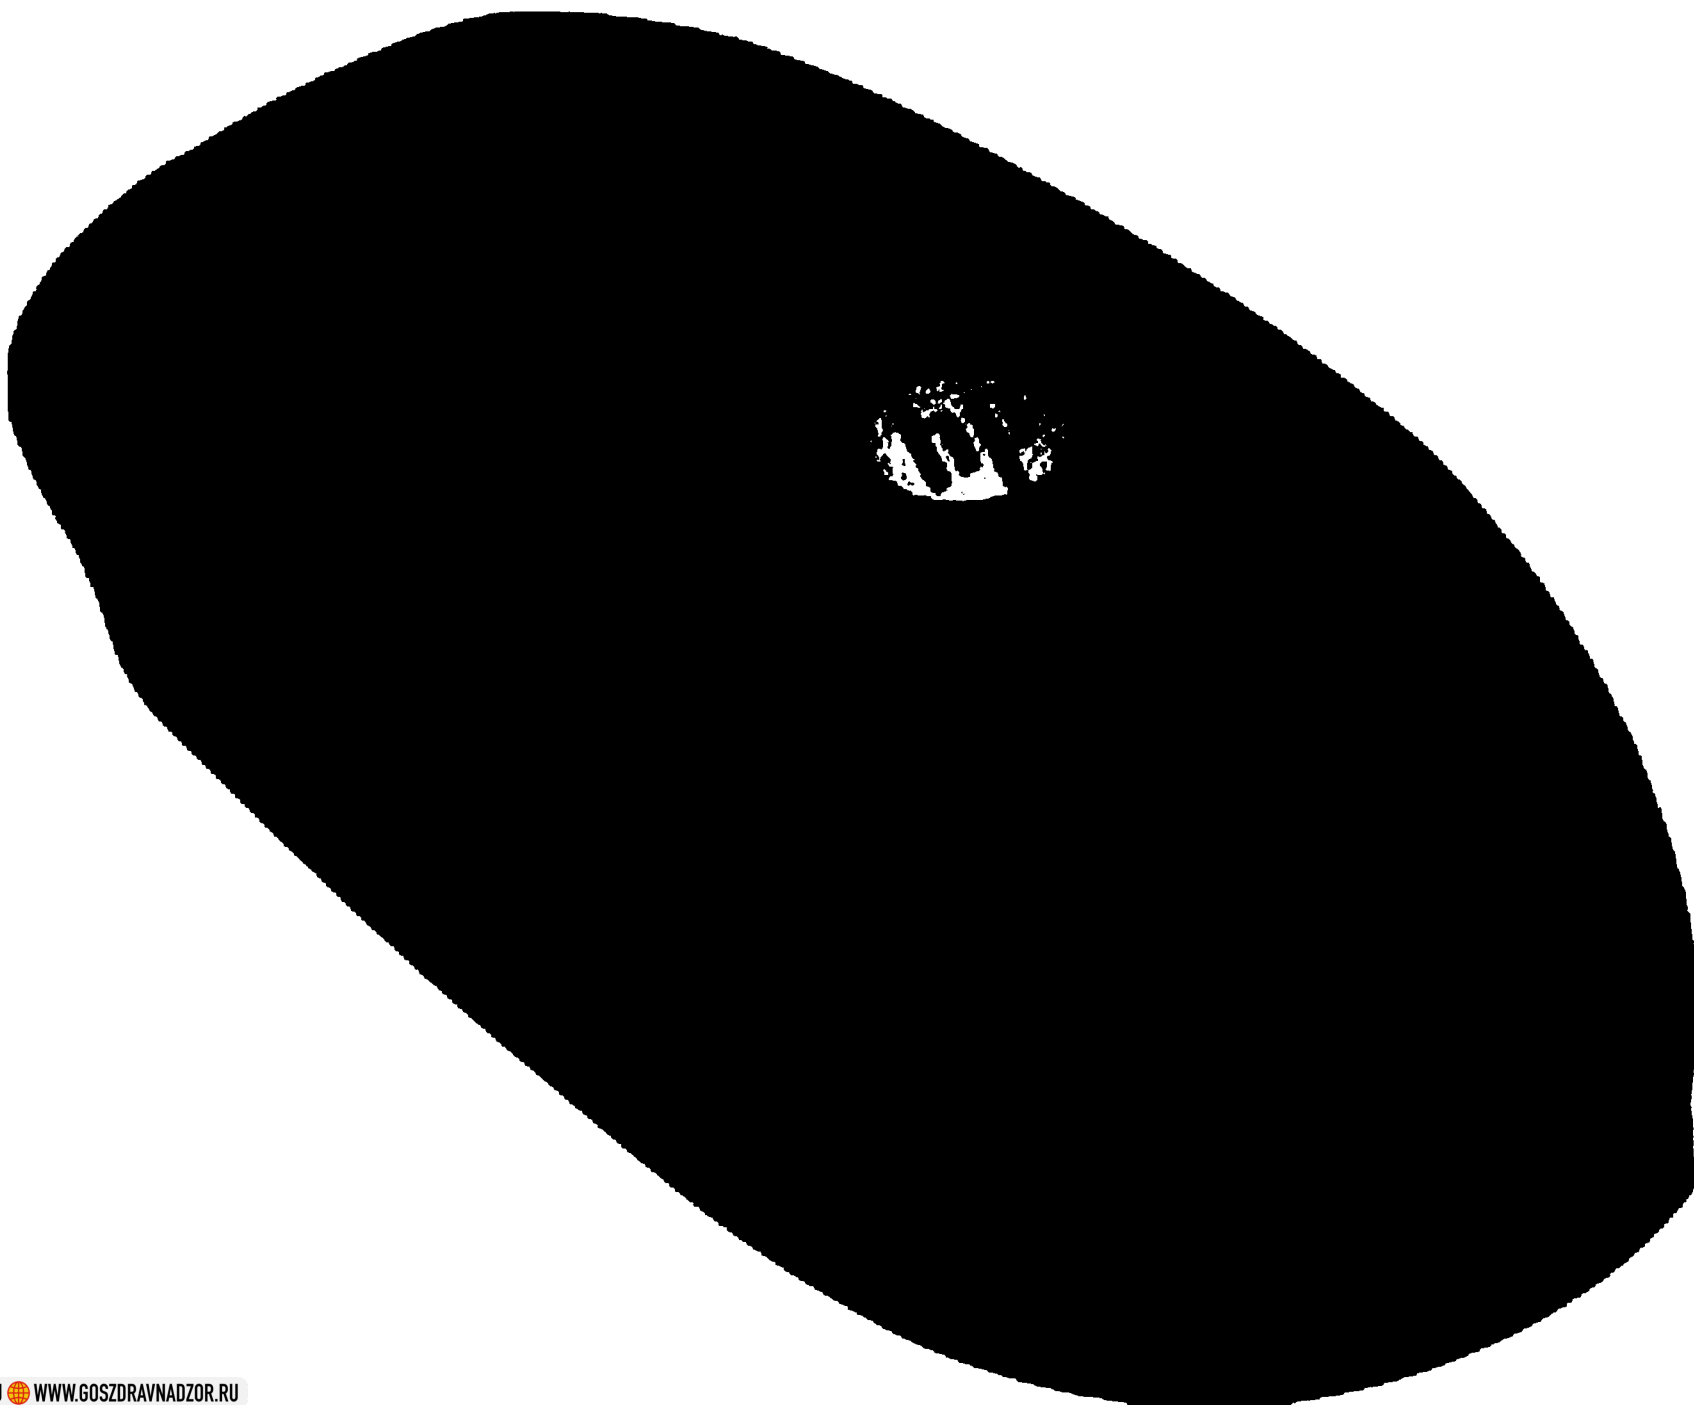

56. Компрессор газовый.

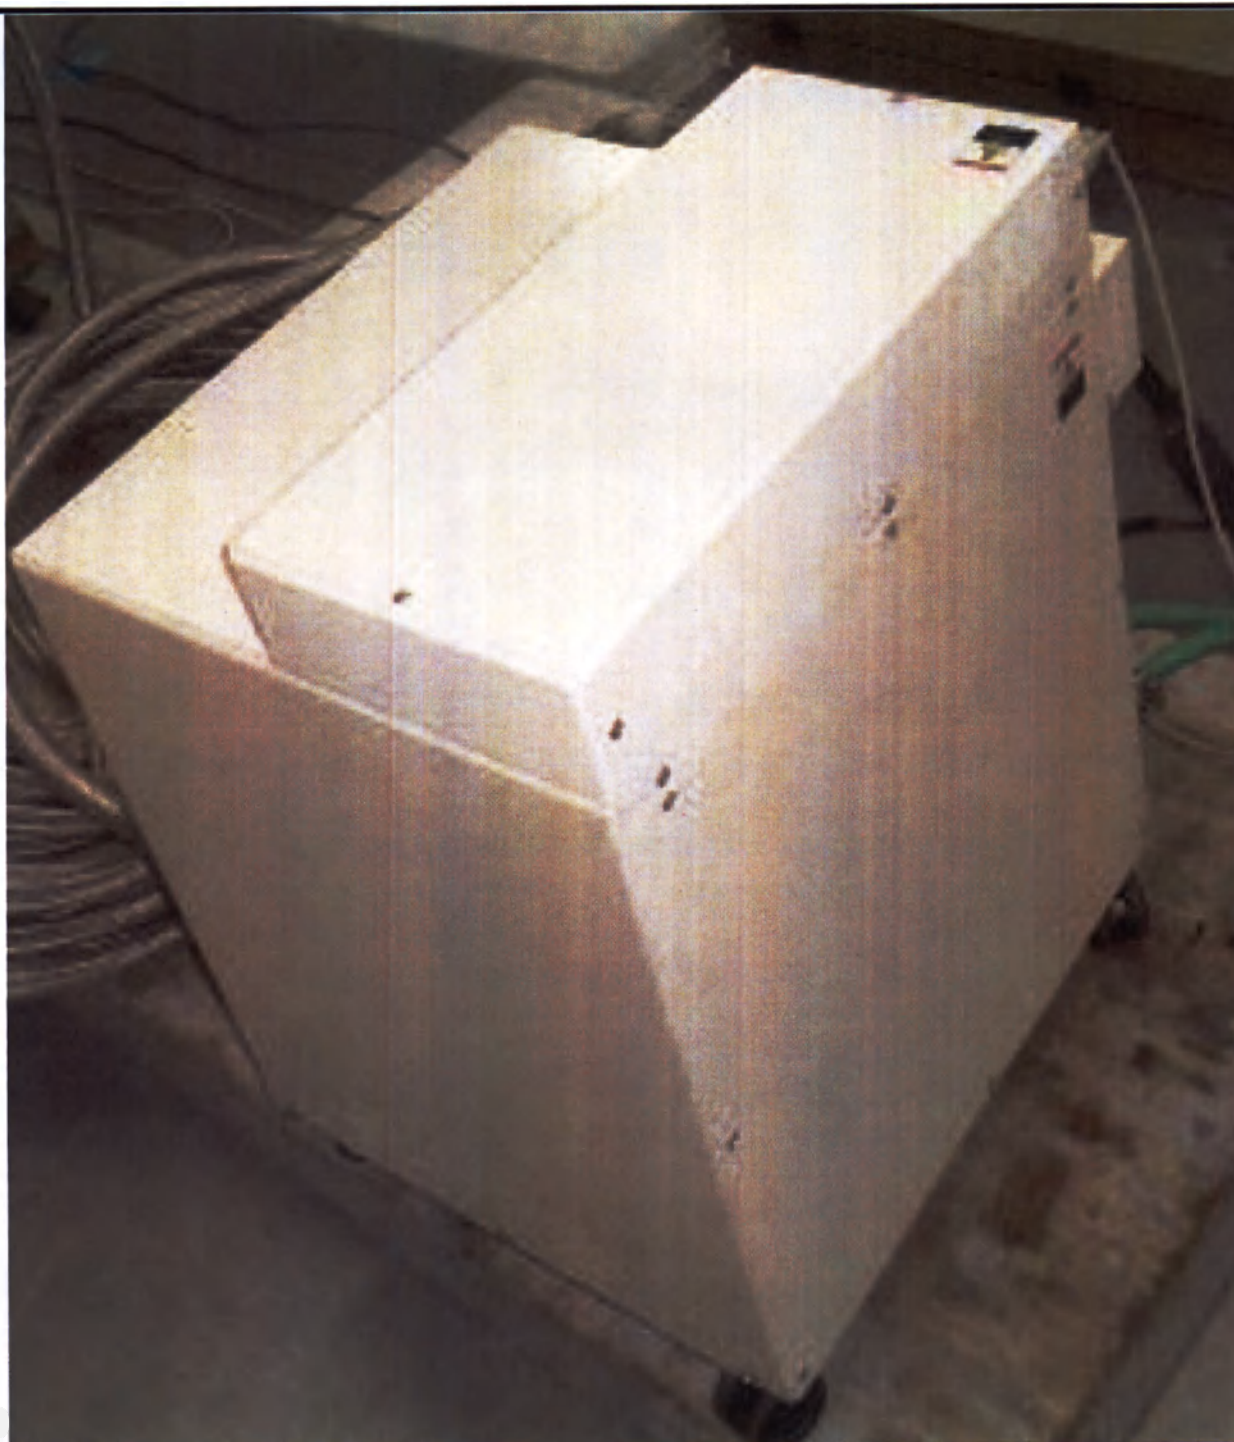

56. Компрессор гелиевый.

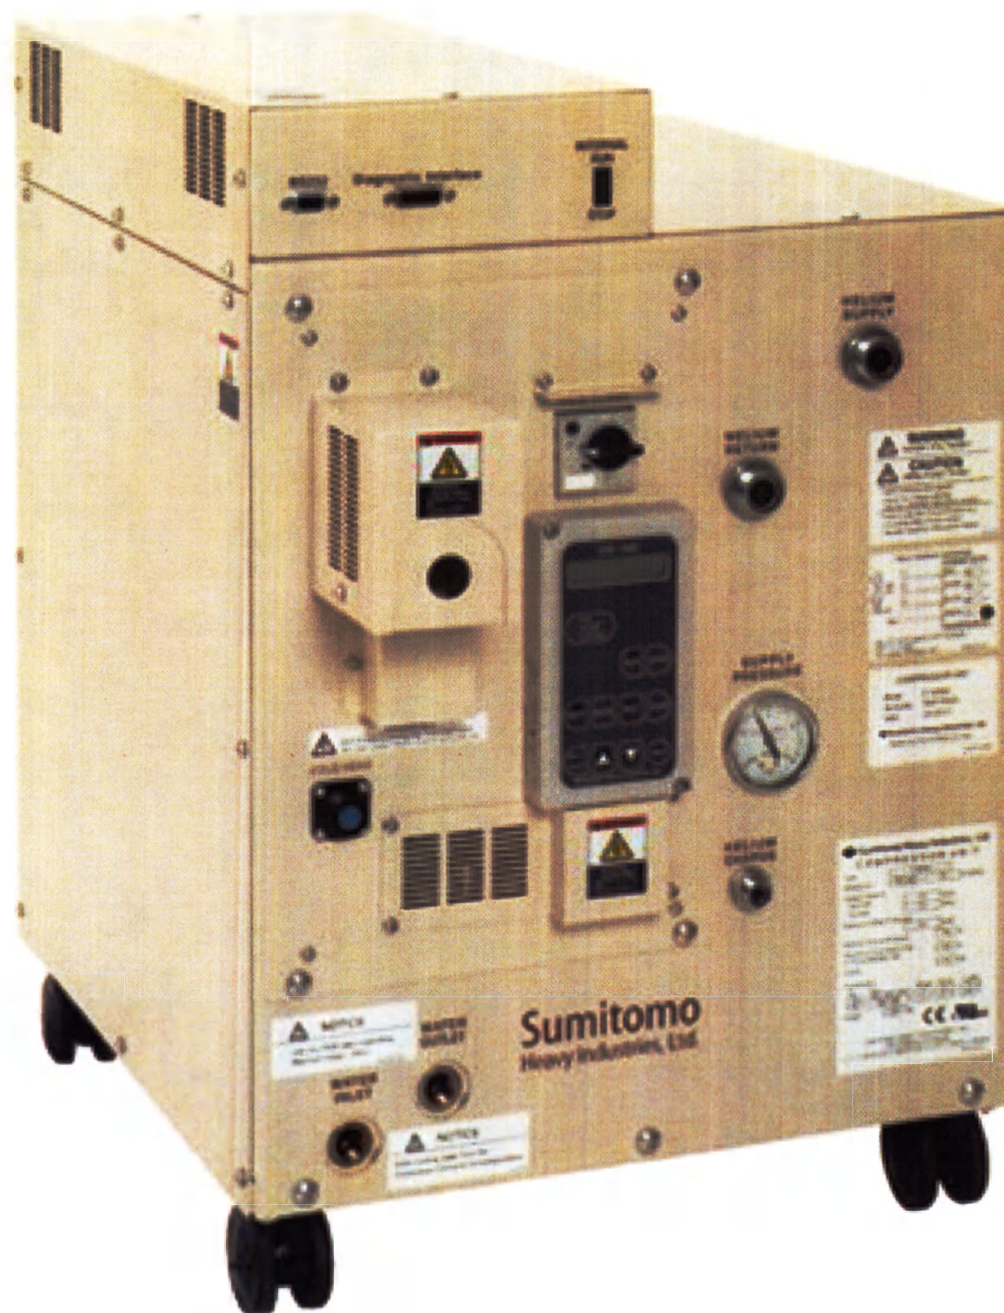

57. Блоки реконструкции (не более 5 шт.).




57. Блоки реконструкции (не более 5 шт.).

57. Блоки реконструкции (не более 5 шт.).




57. Блоки реконструкции (не более 5 шт.).

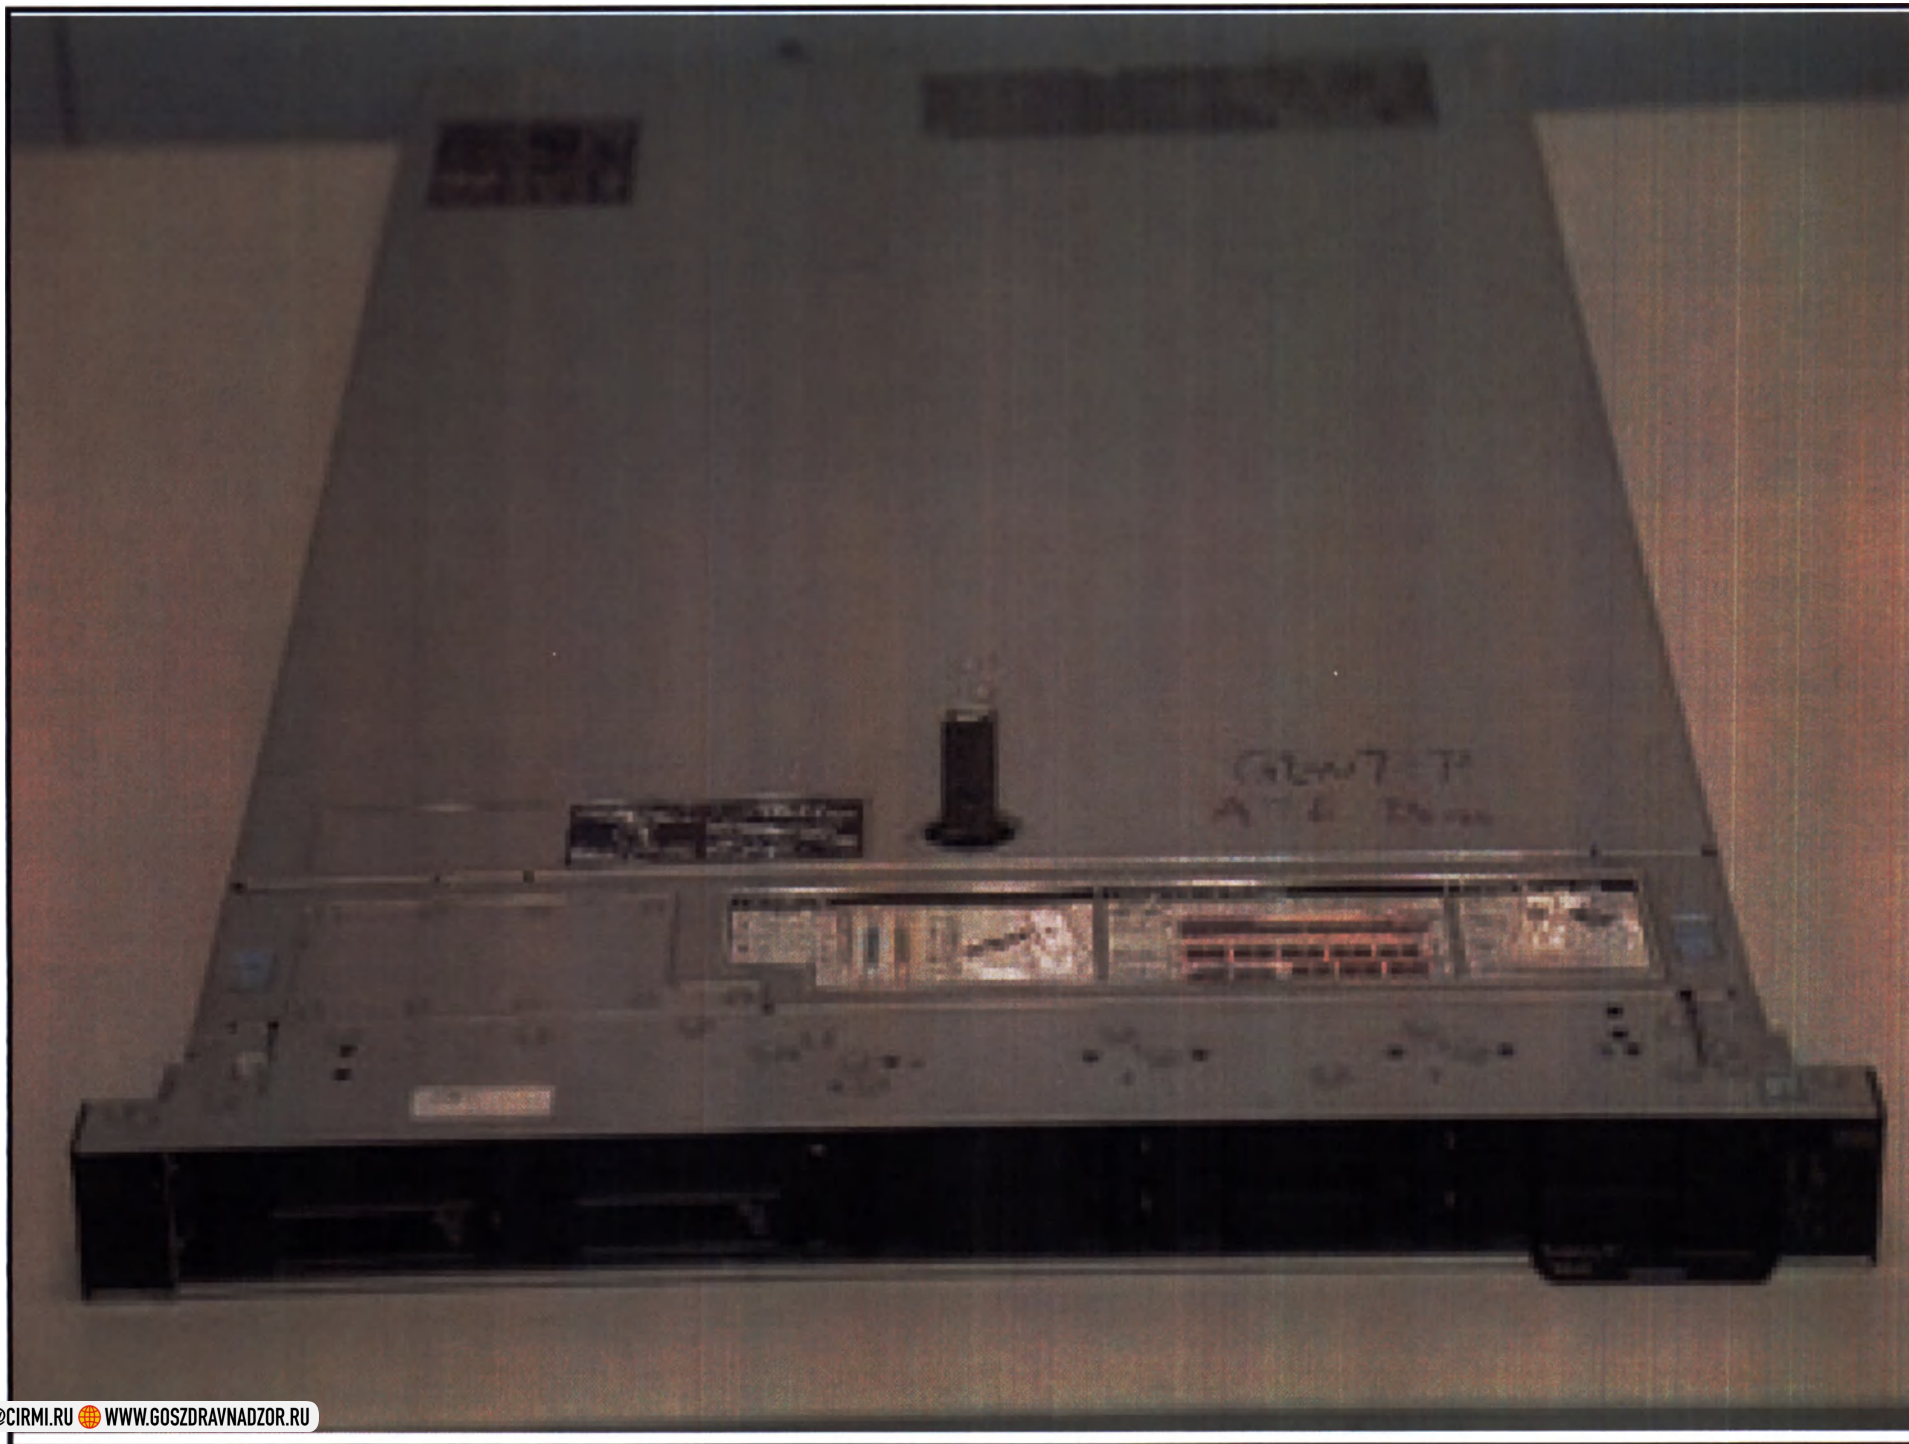


57. Блоки реконструкции (не более 5 шт.).



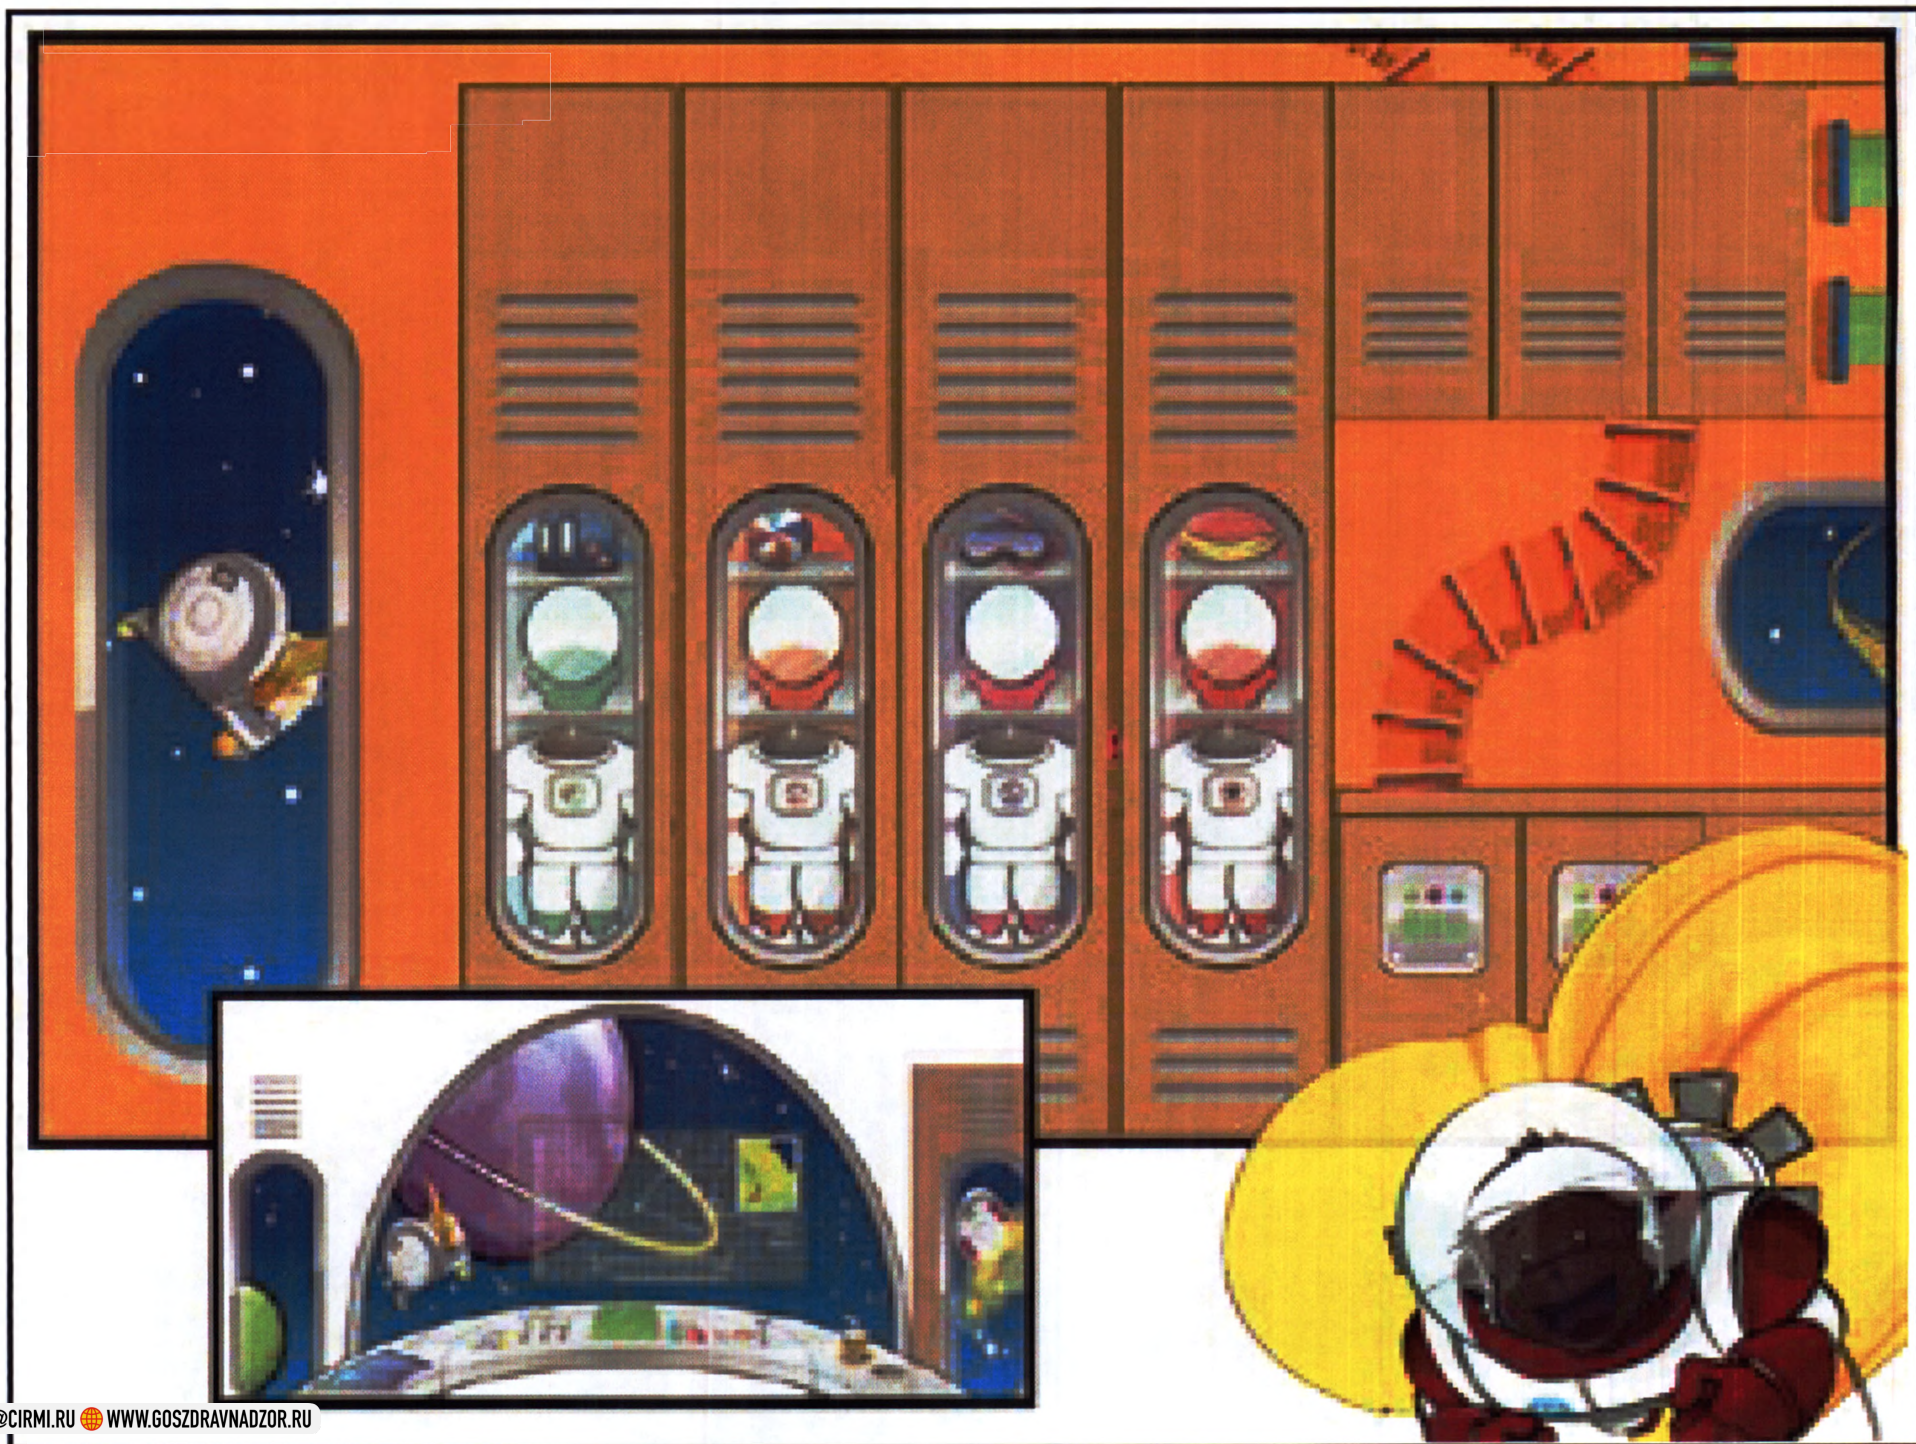





58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

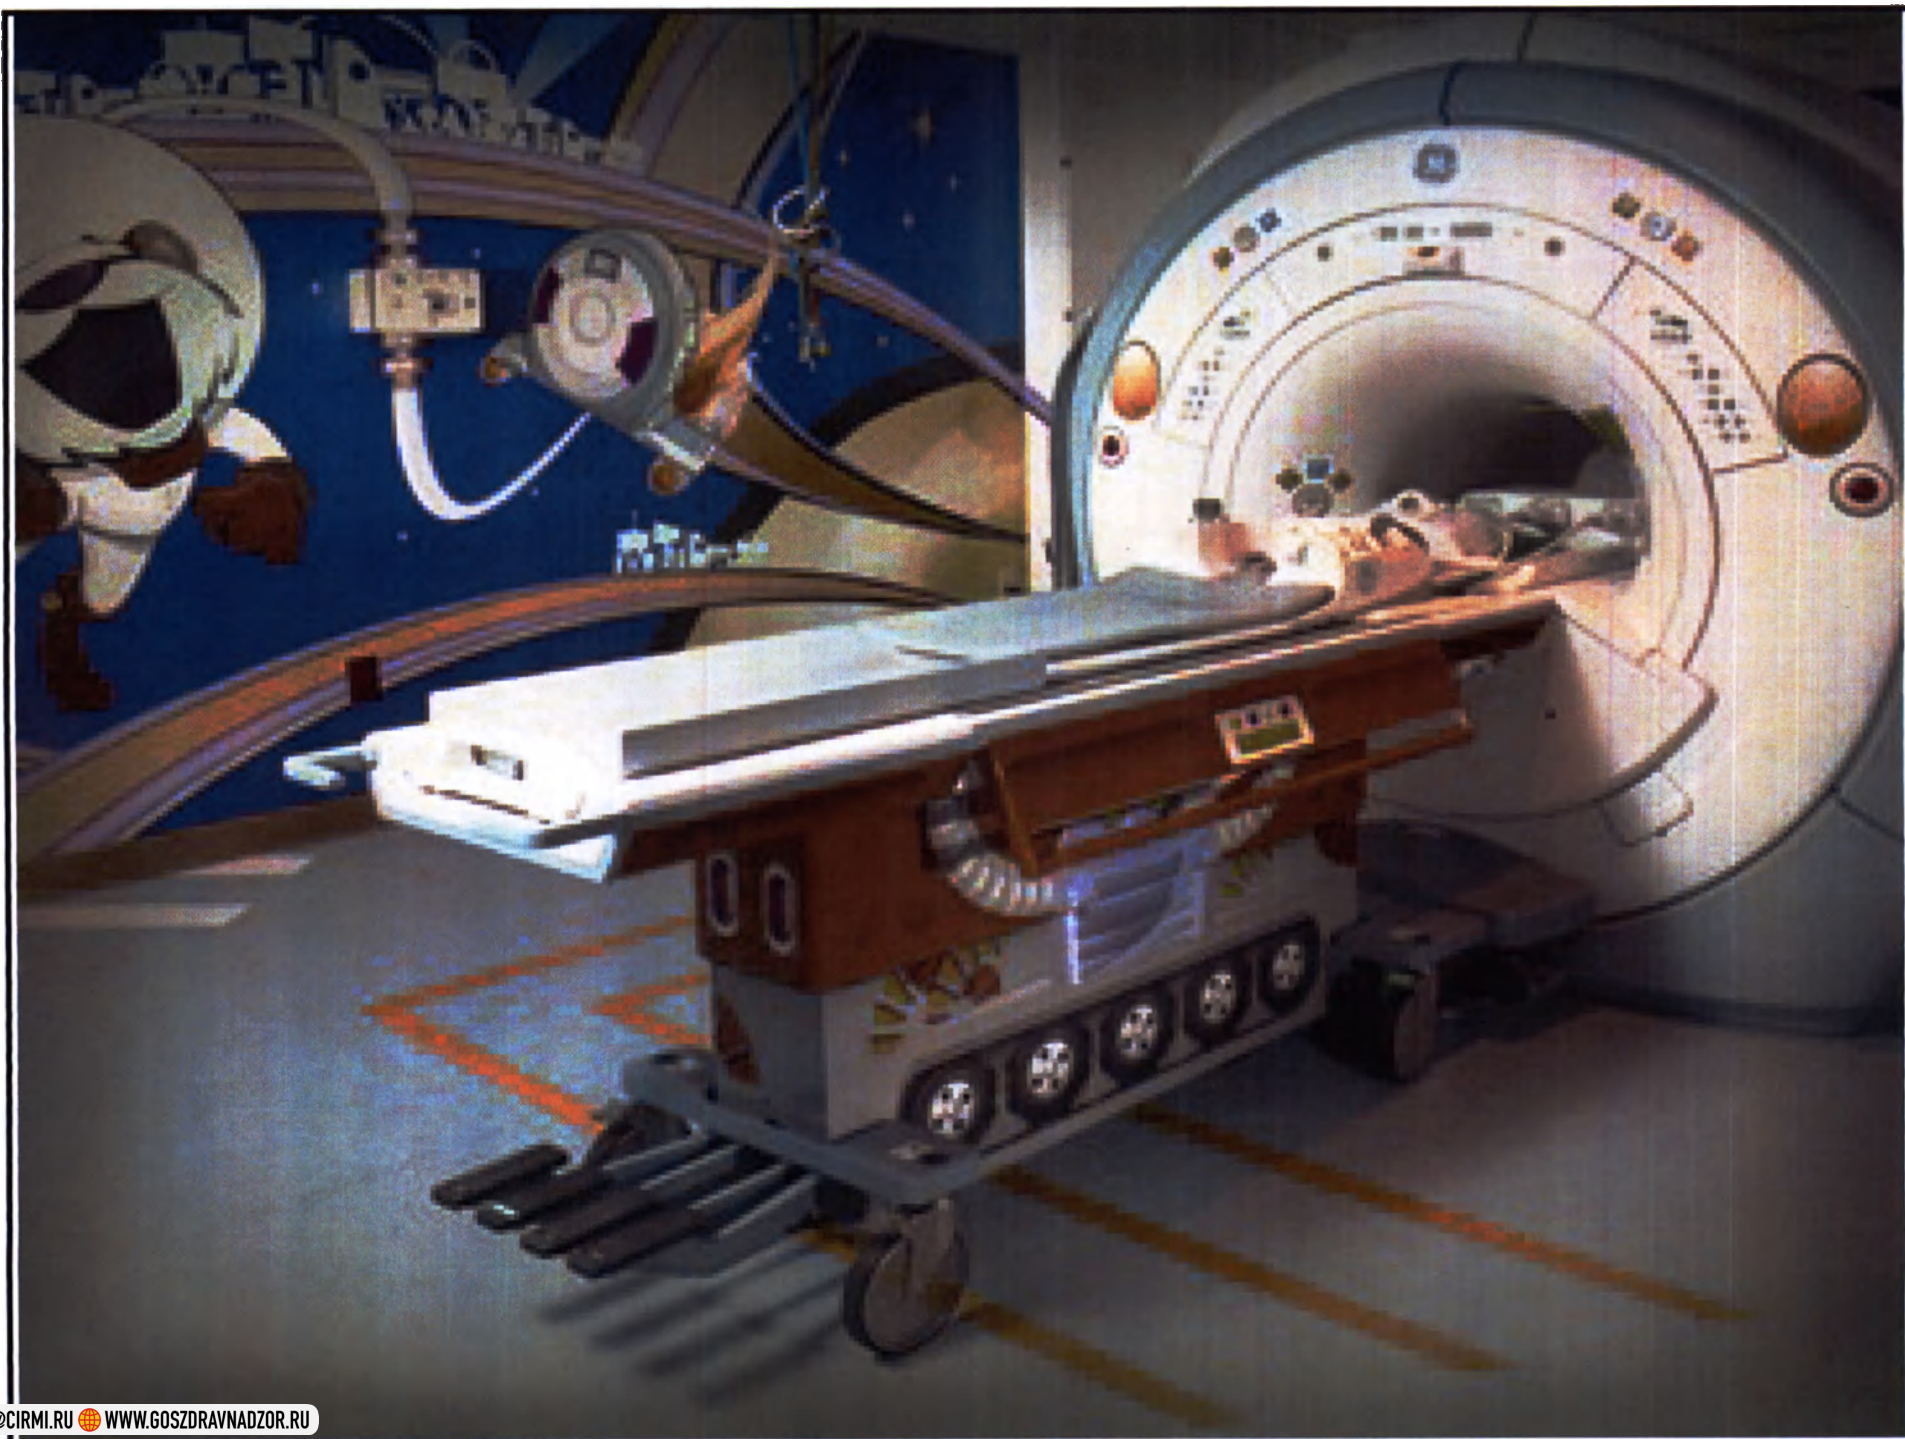


58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

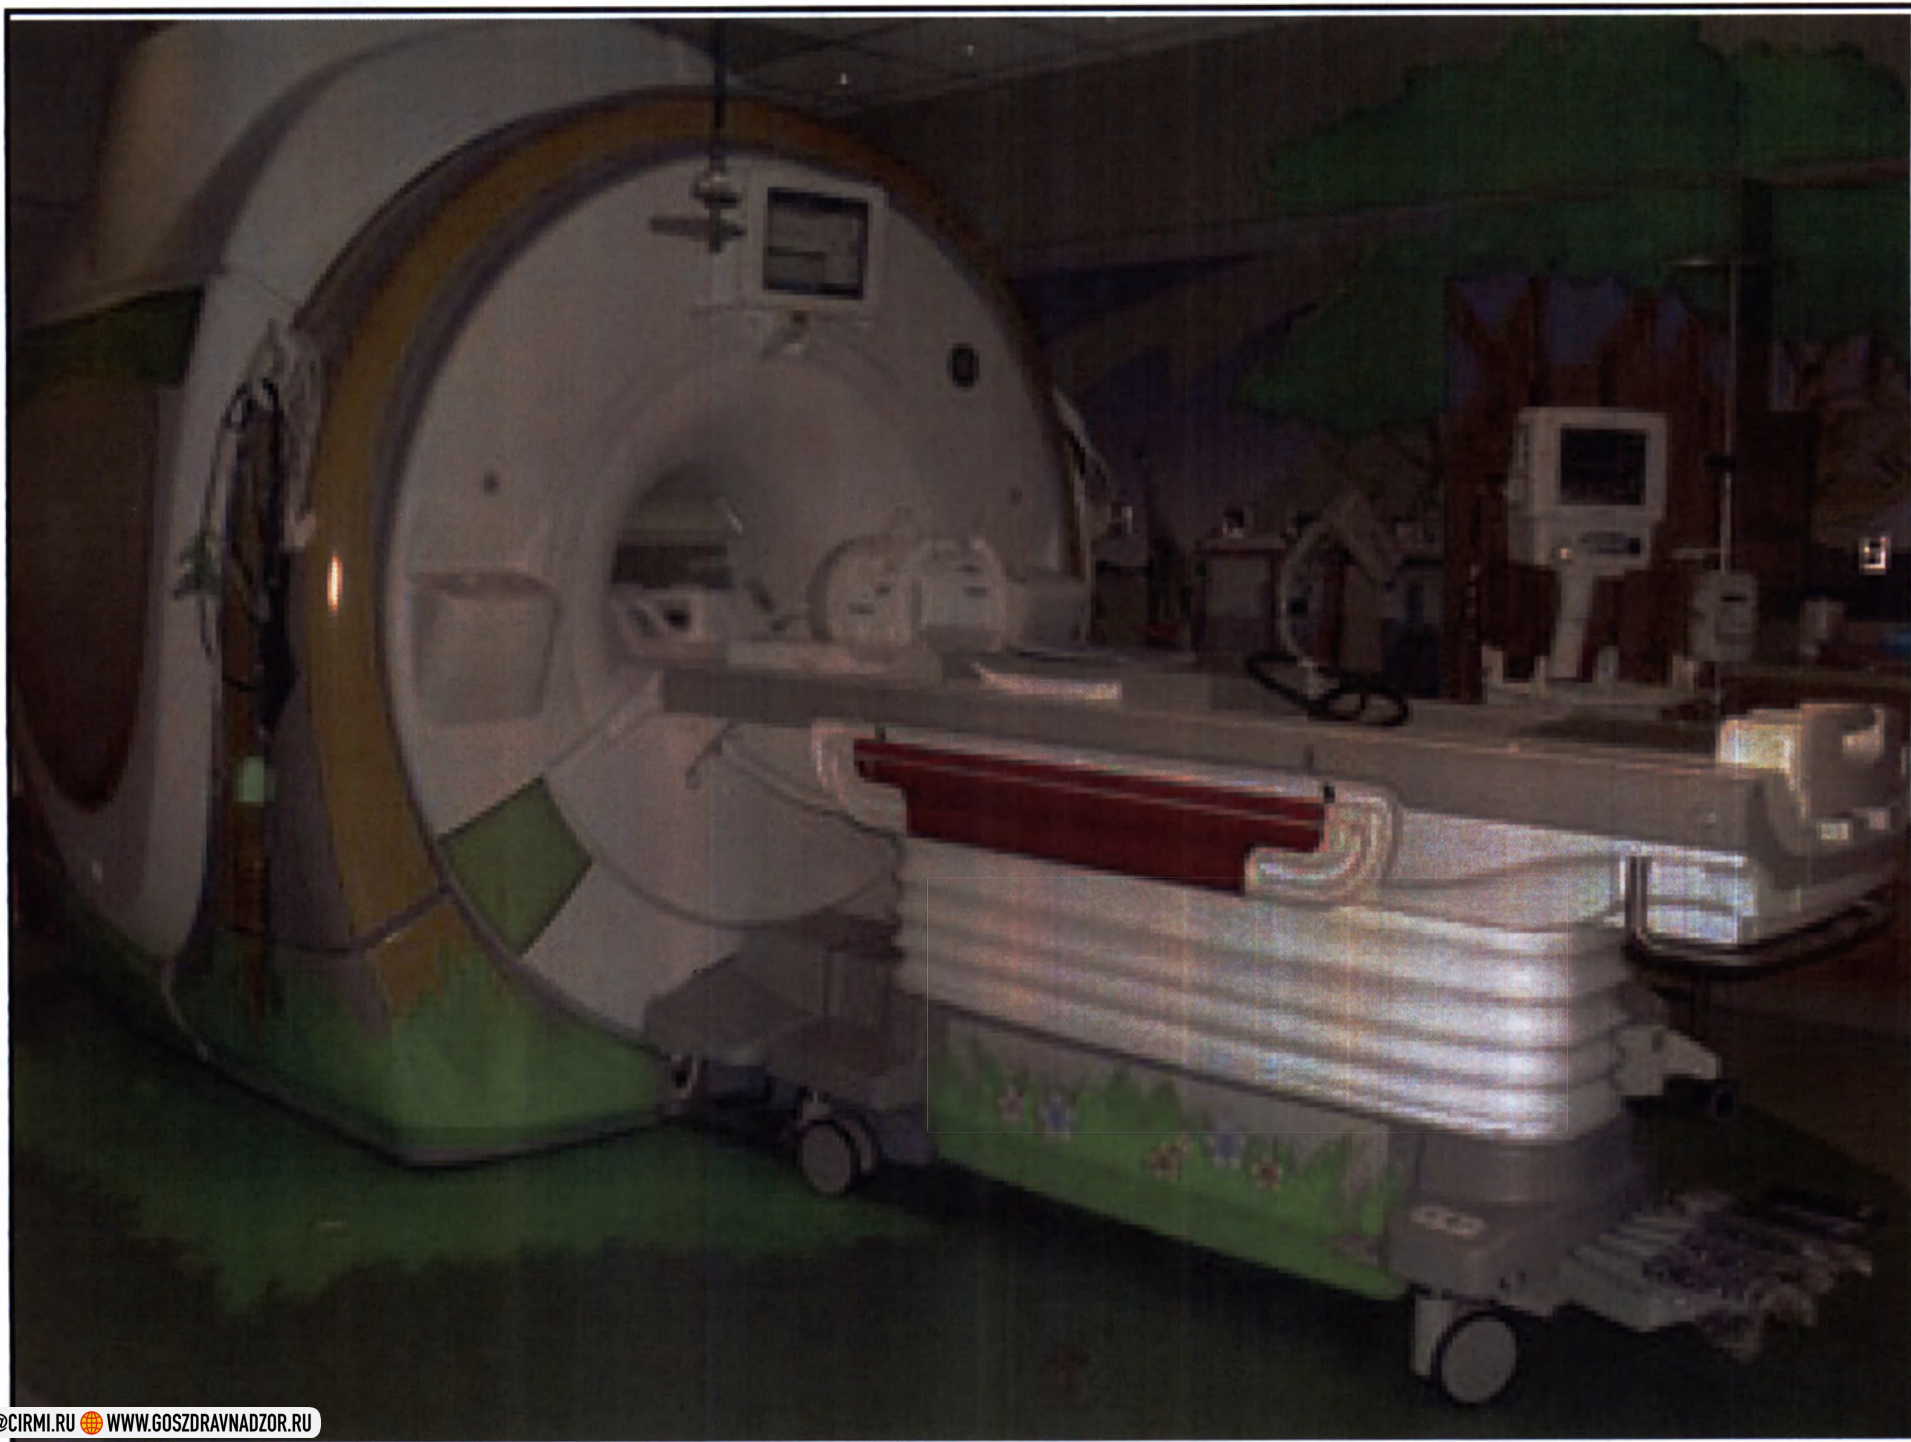



58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

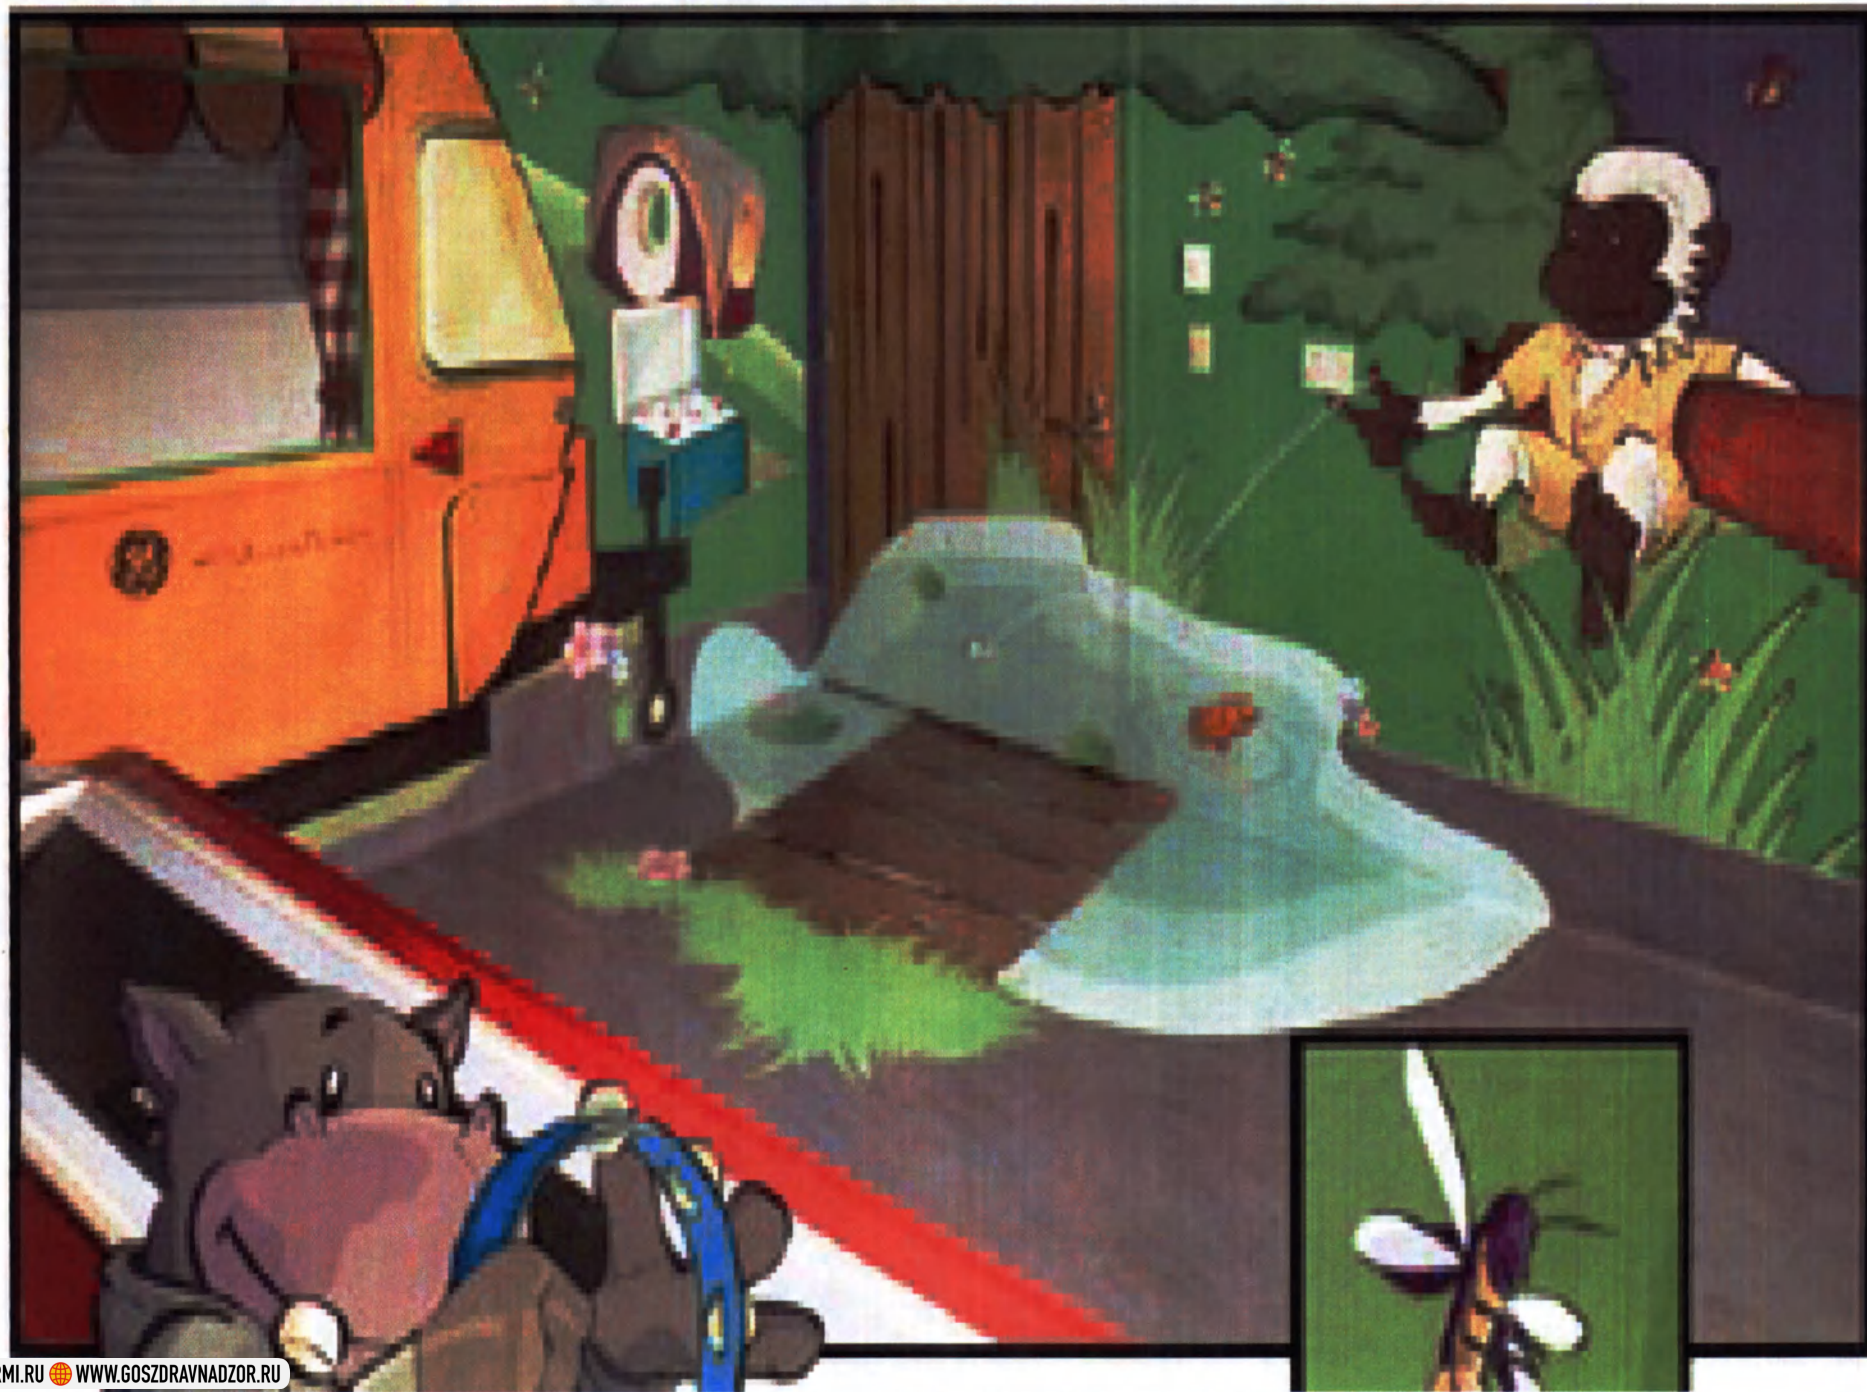

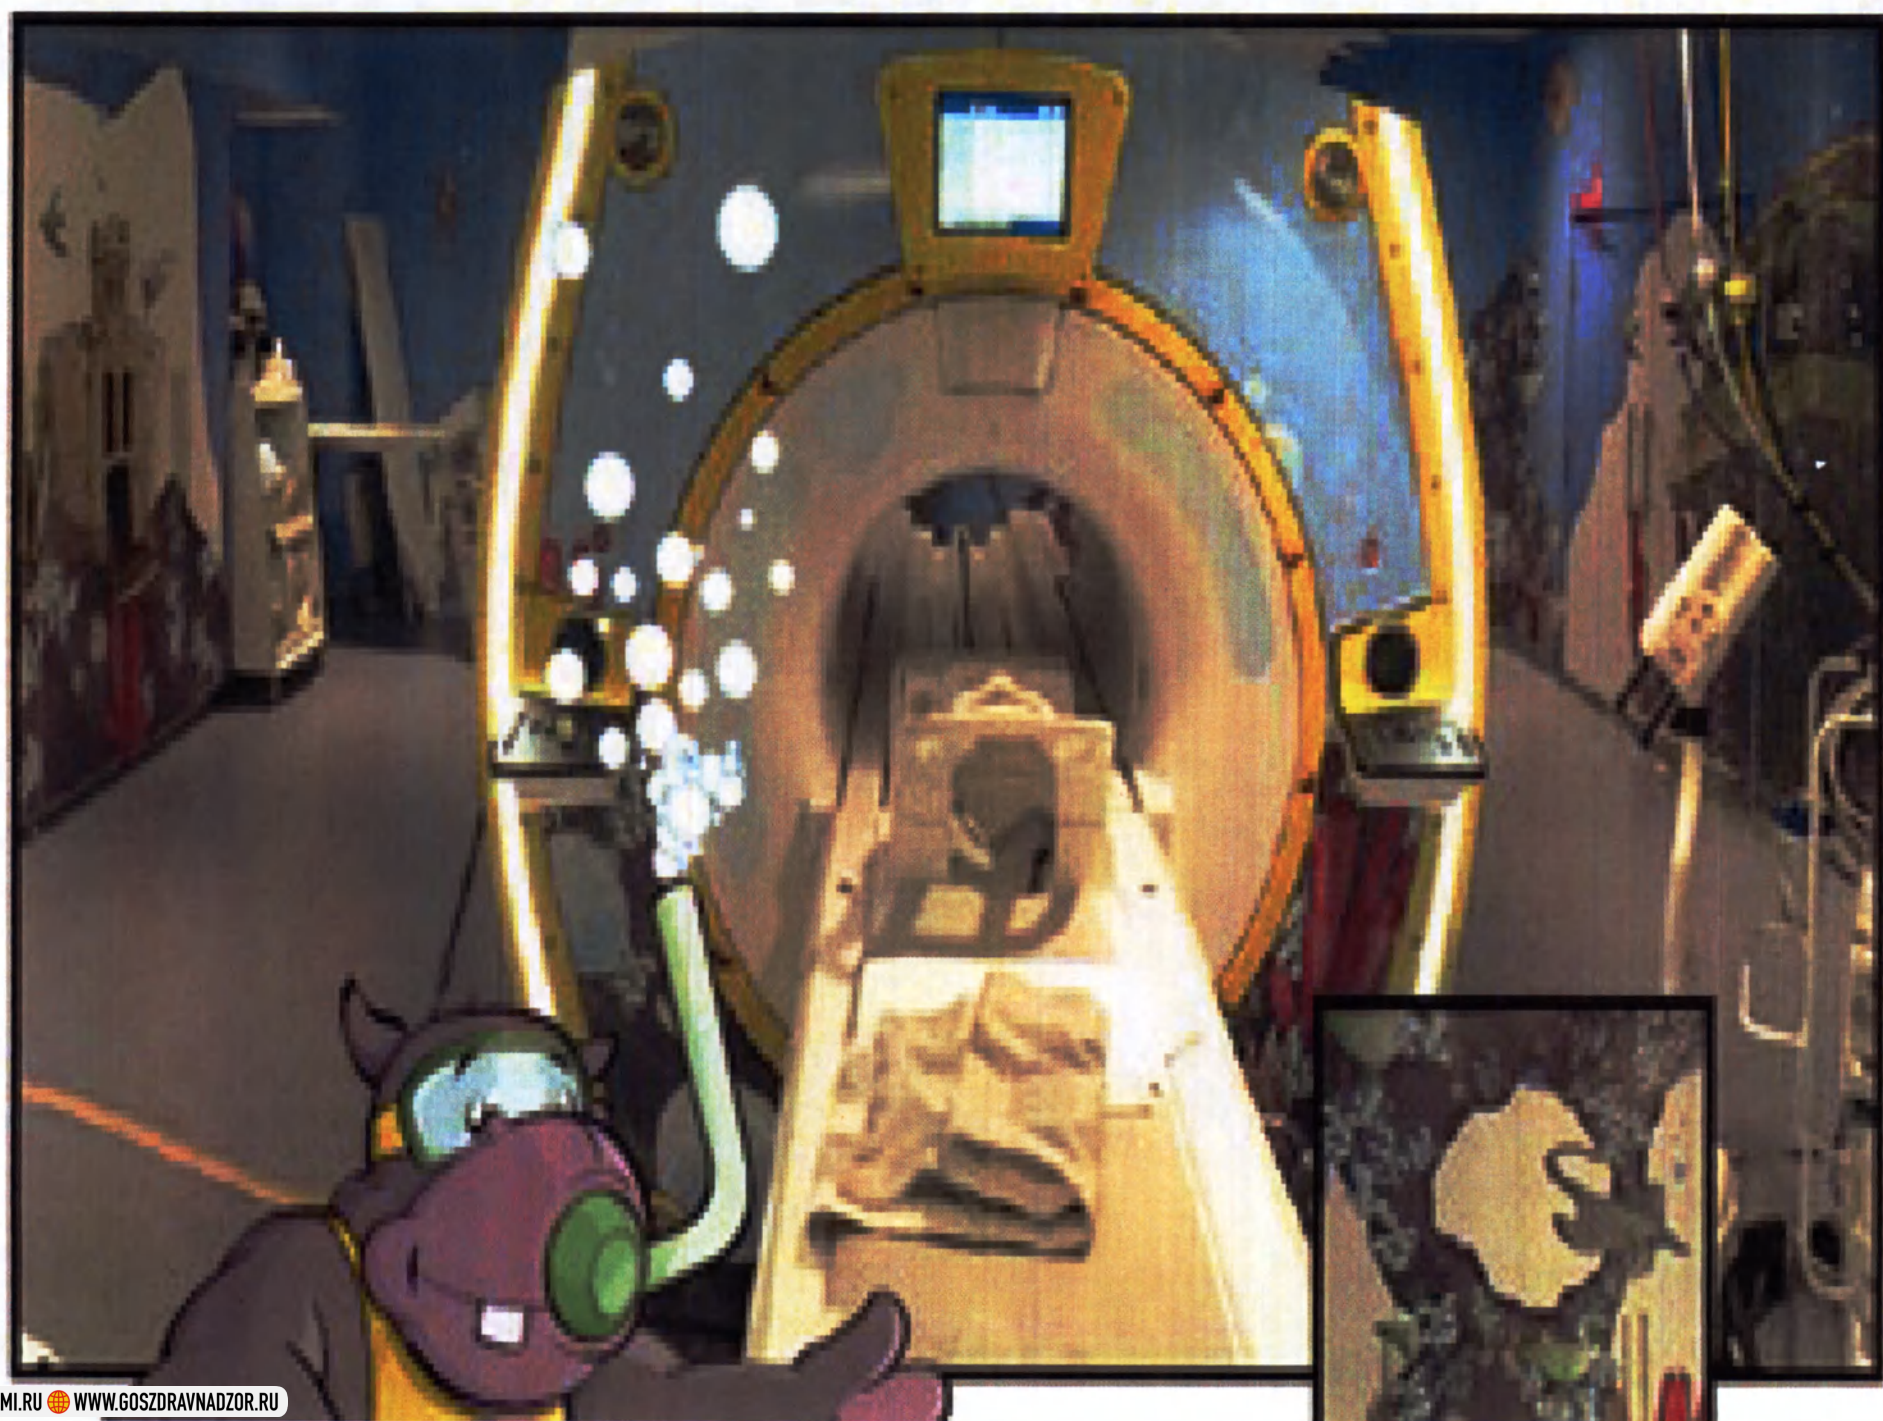

58. Декоративные наклейки (не более 100 шт.).

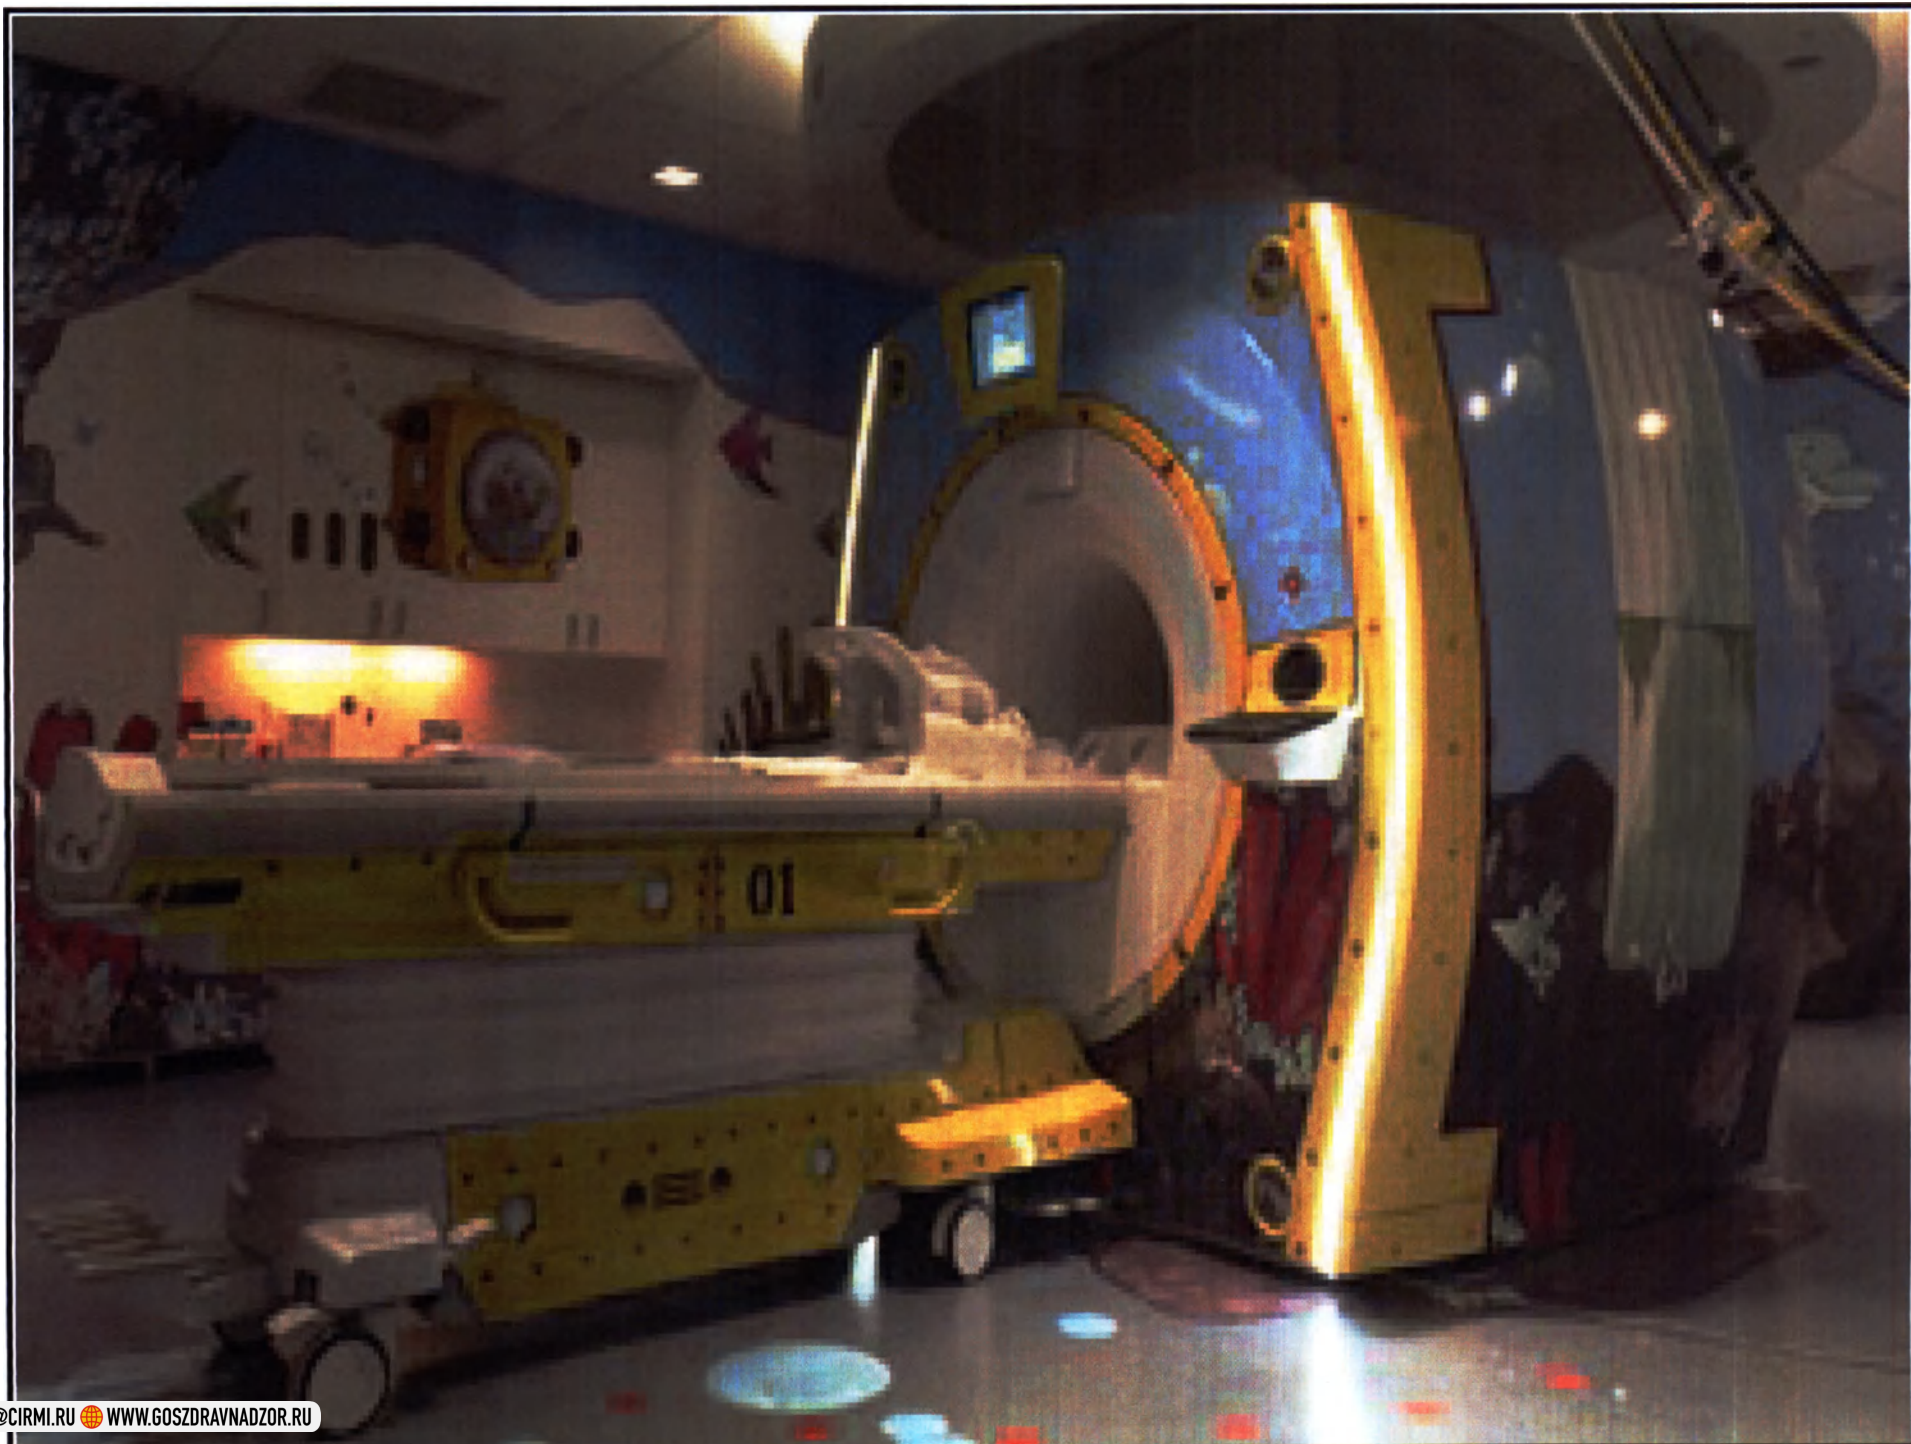


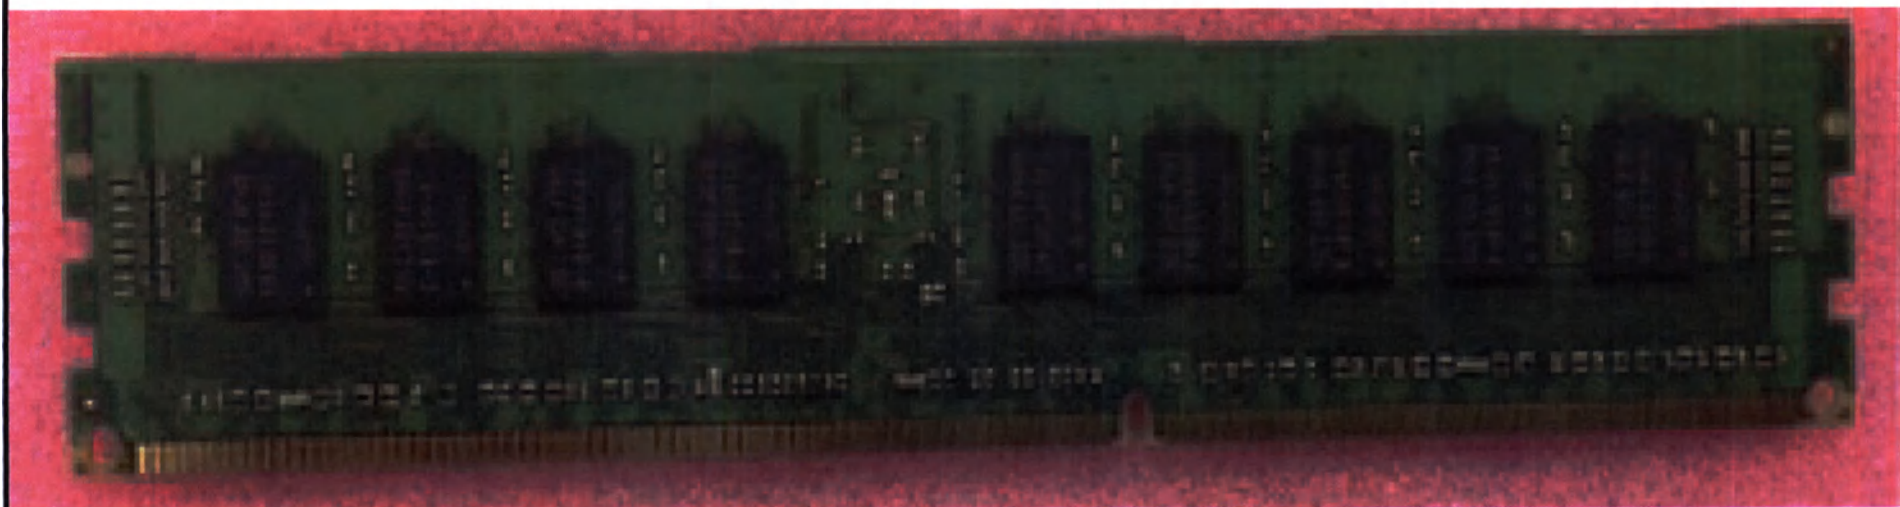


59. Модуль памяти.



60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).

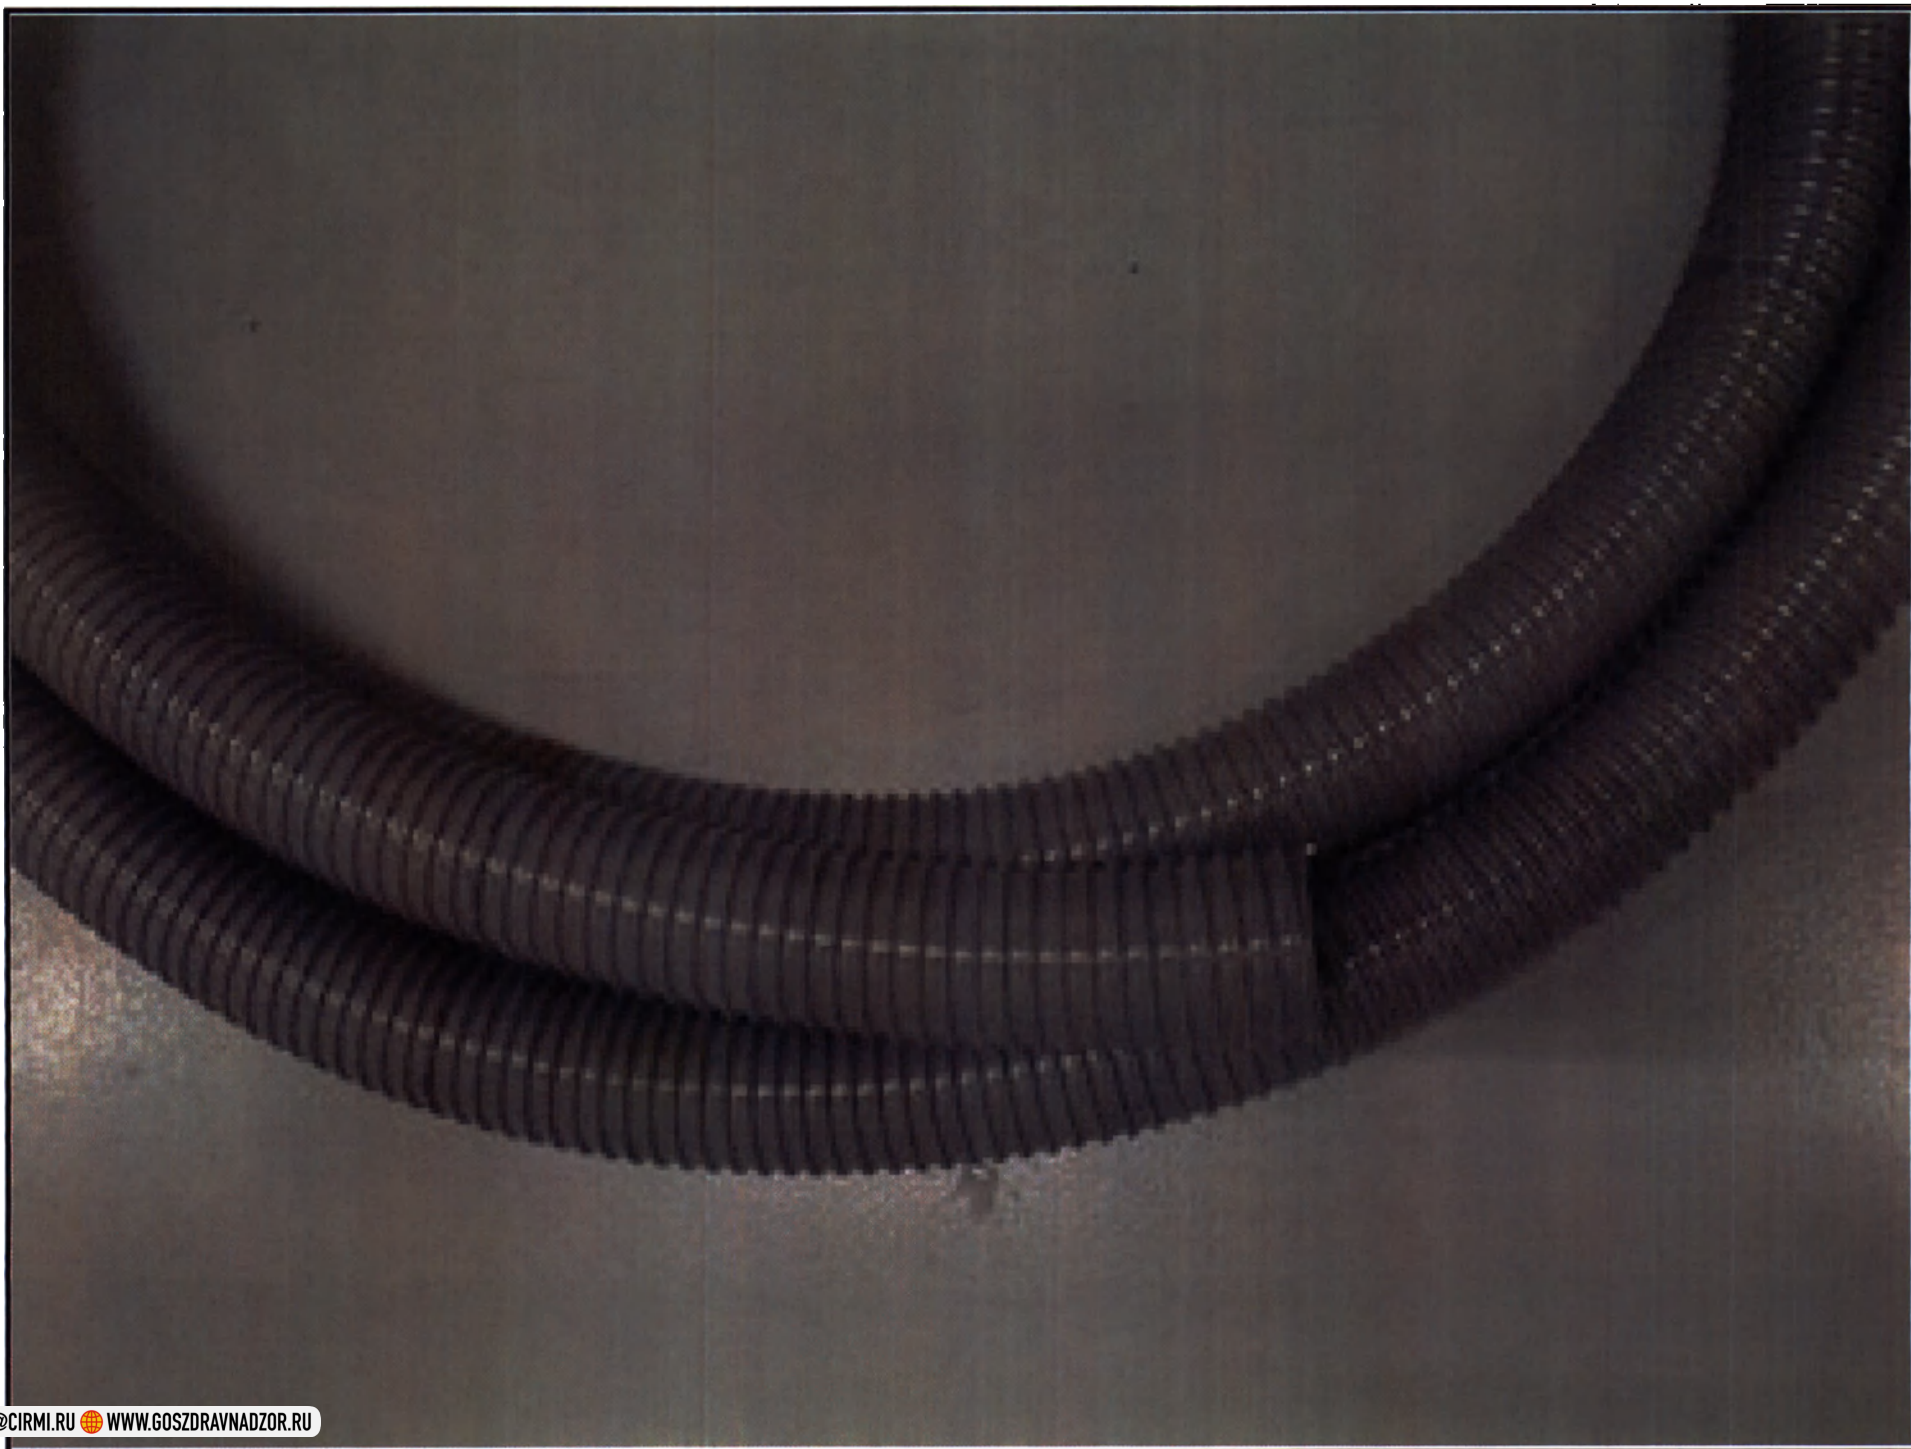

60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).

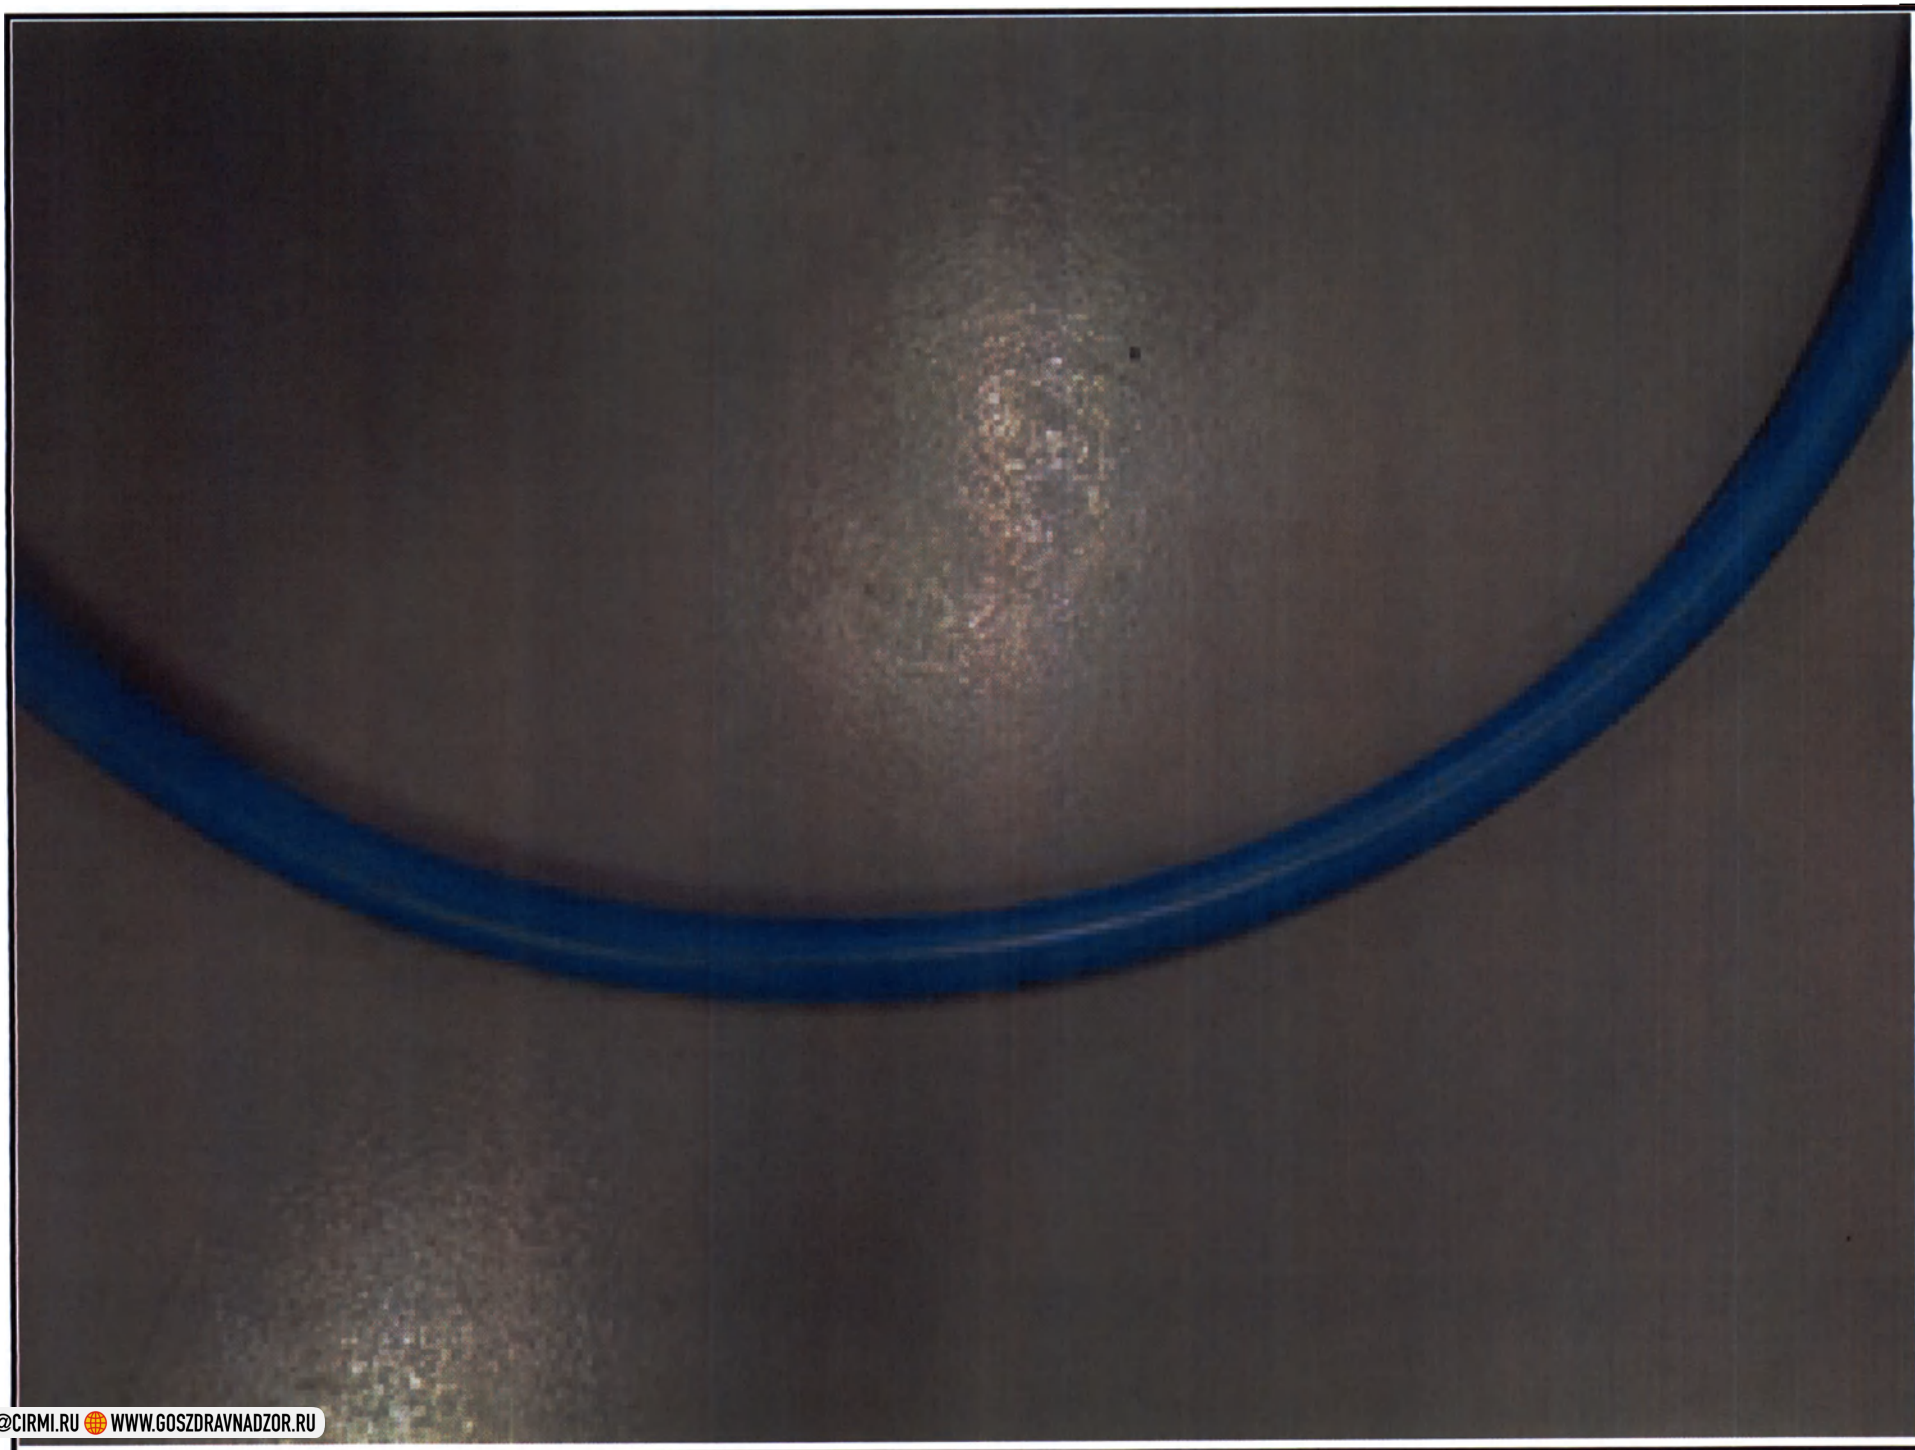

60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).



60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).



60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).




60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).




60. Шланги для охлаждения МР-томографа (не более 50 шт.).



61. Блок управления сигнальной системы для пациента.

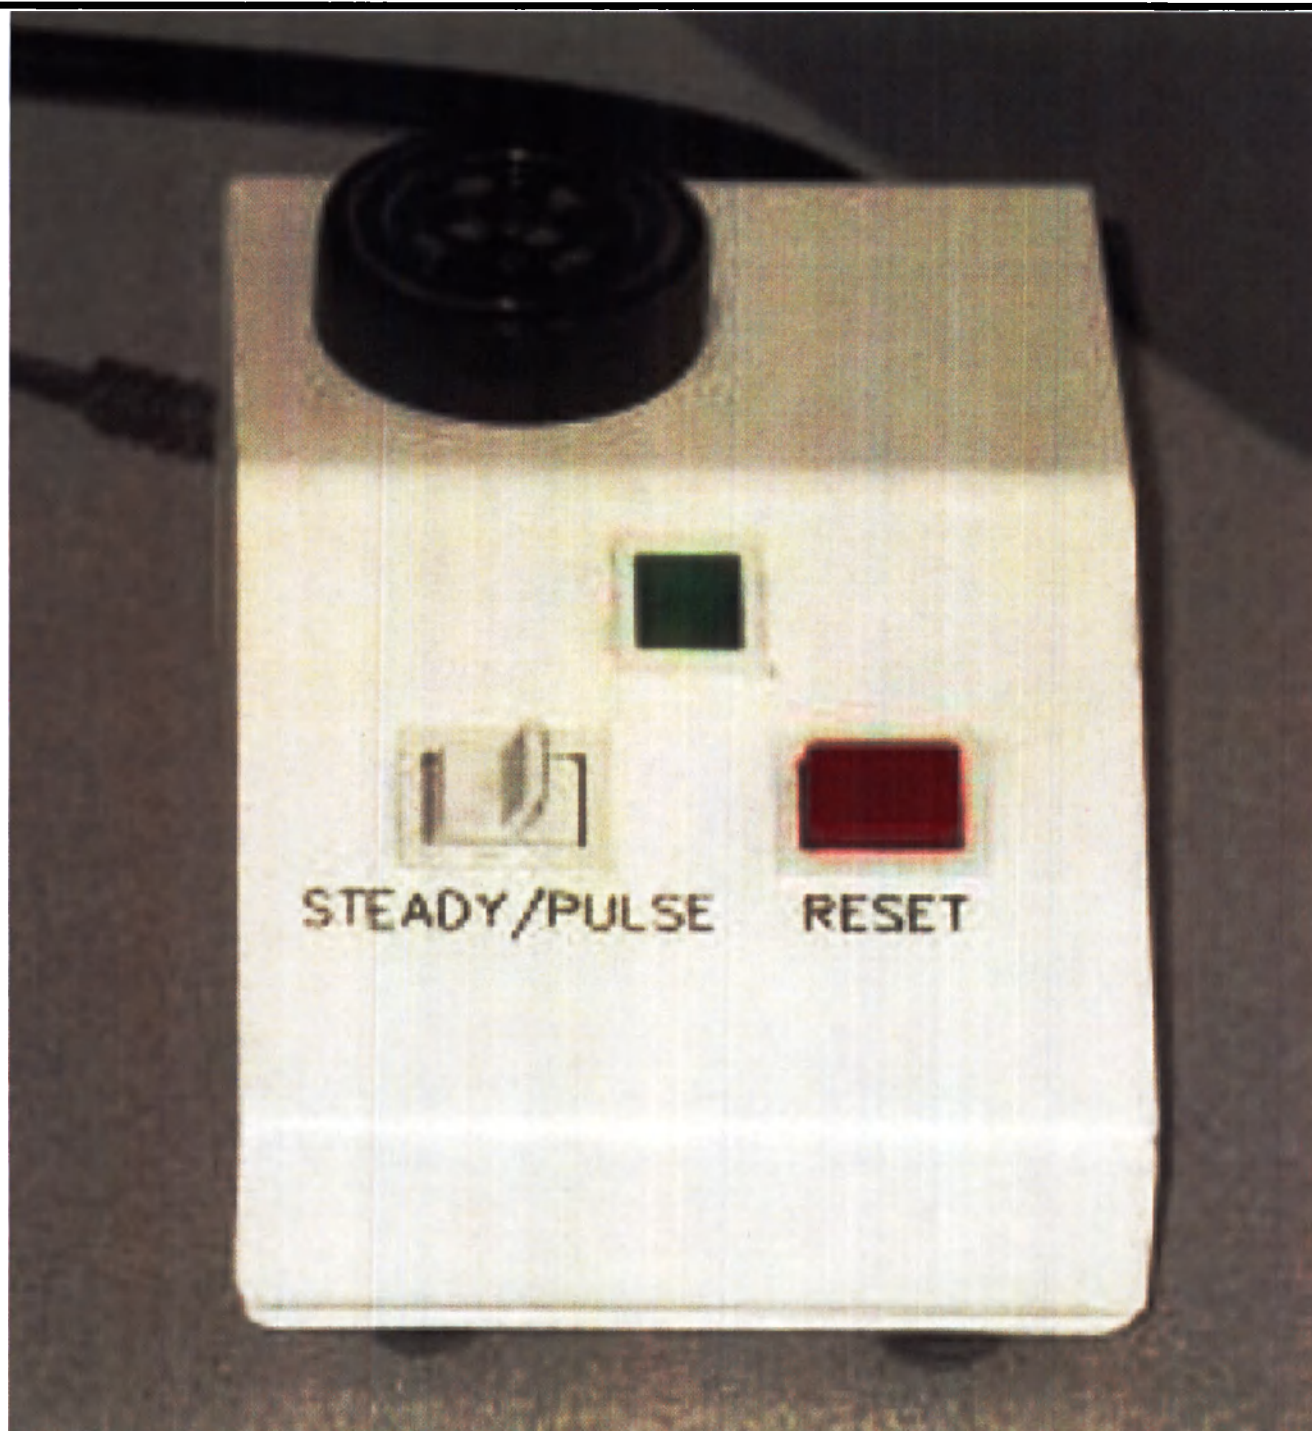


61. Блок управления сигнальной системы для пациента.

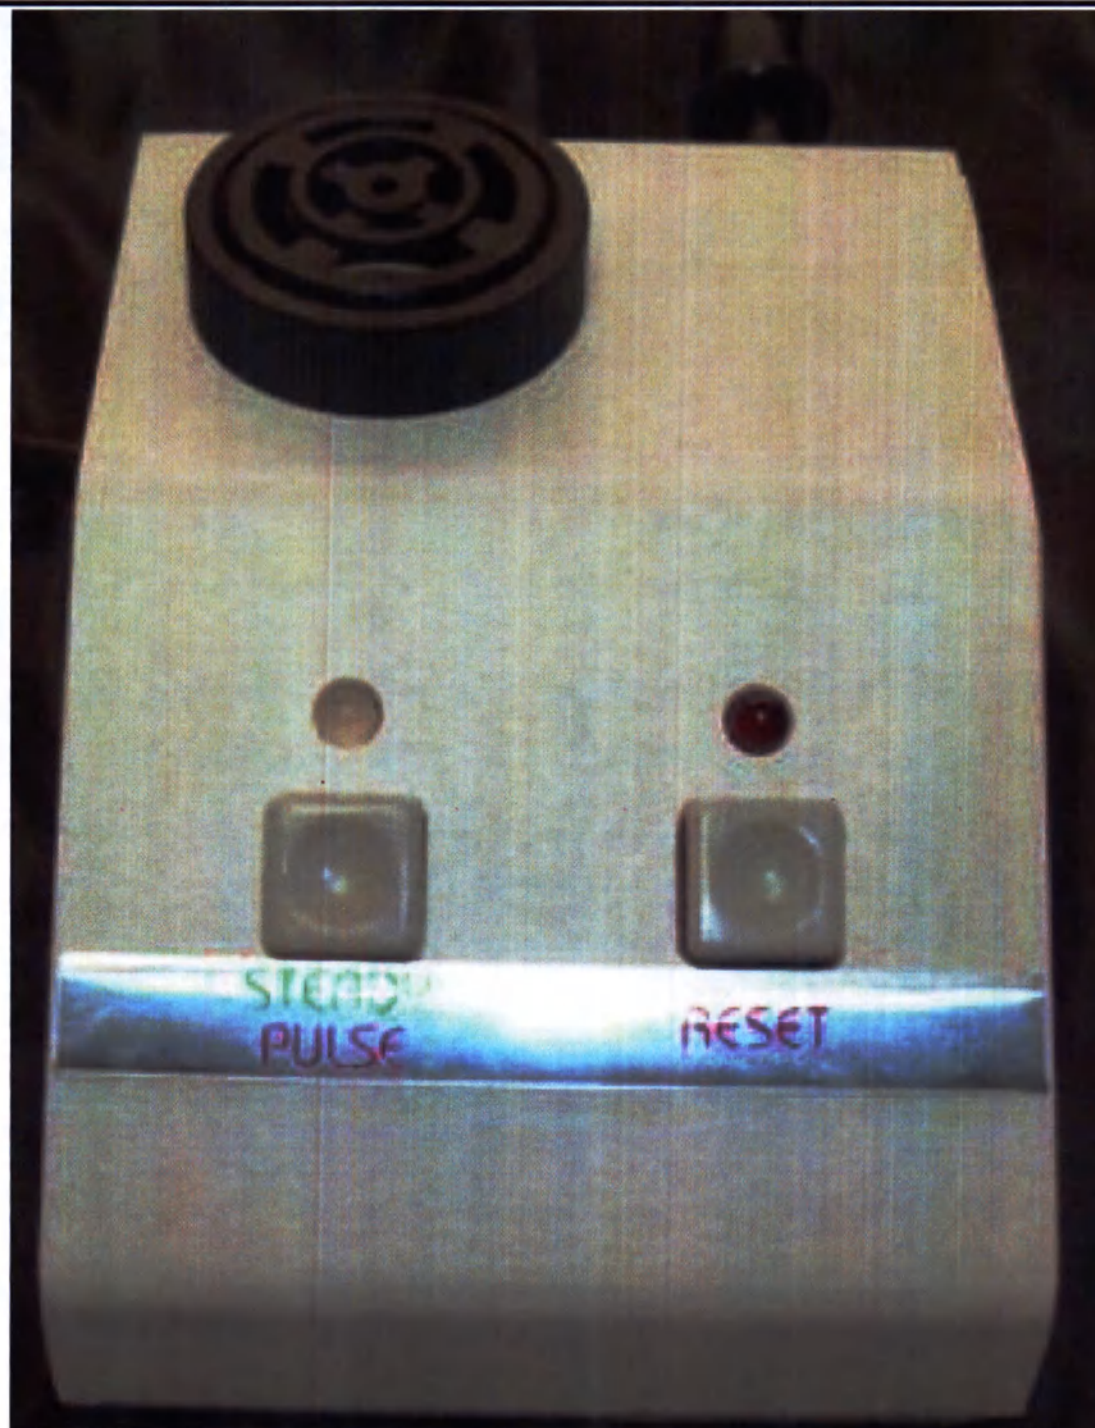

61. Блок управления сигнальной системы для пациента.



61. Блок управления сигнальной системы для пациента.

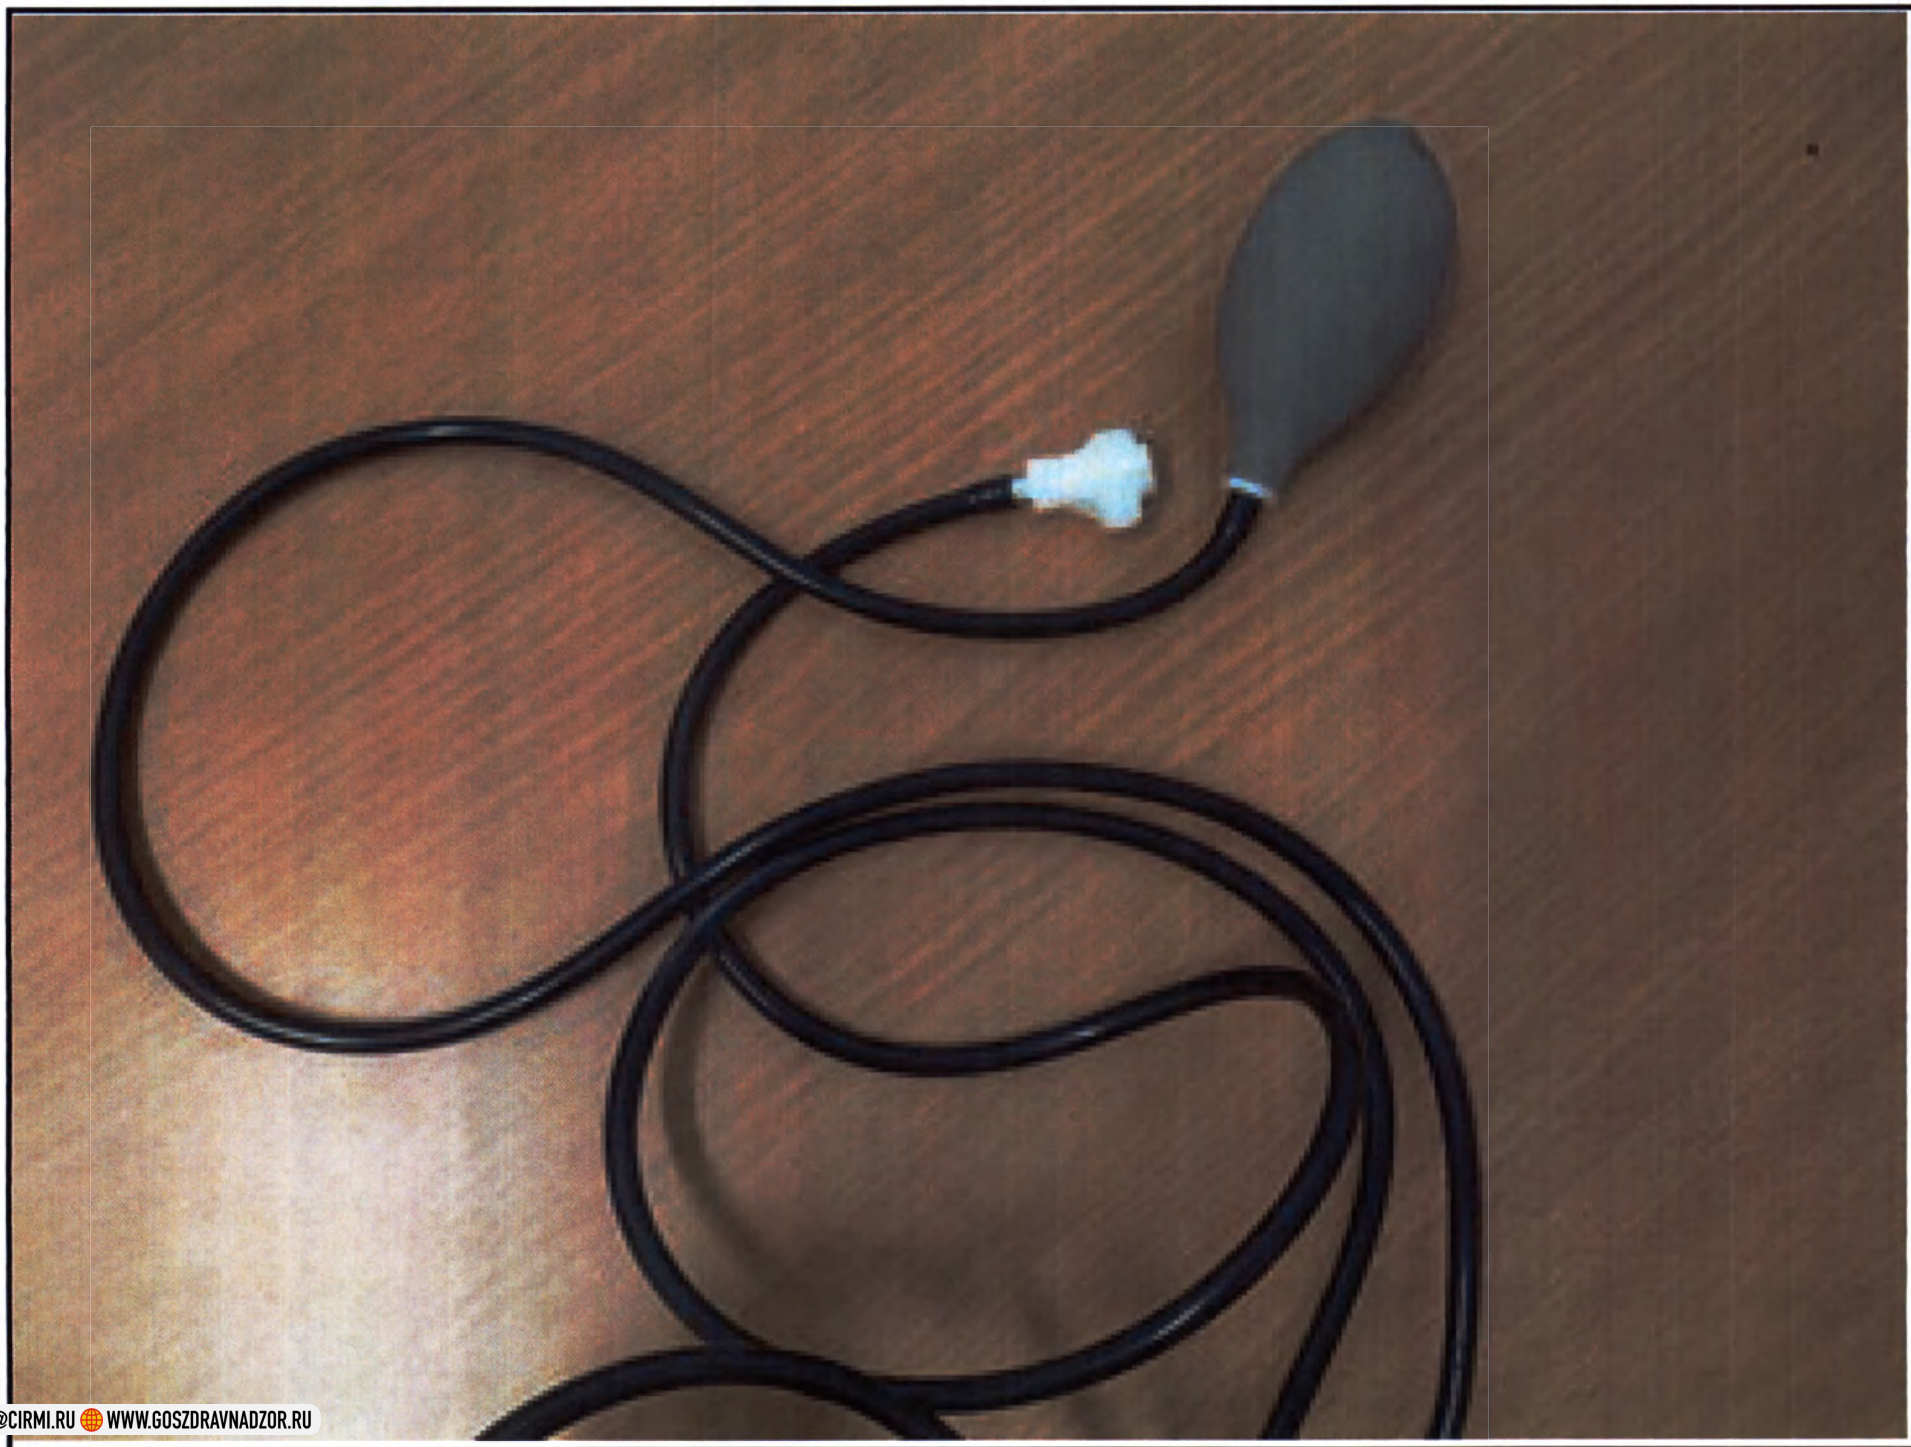


62. Серверные стойки (не более 5 шт.).




62. Серверные стойки (не более 5 шт.).




62. Серверные стойки (не более 5 шт.).

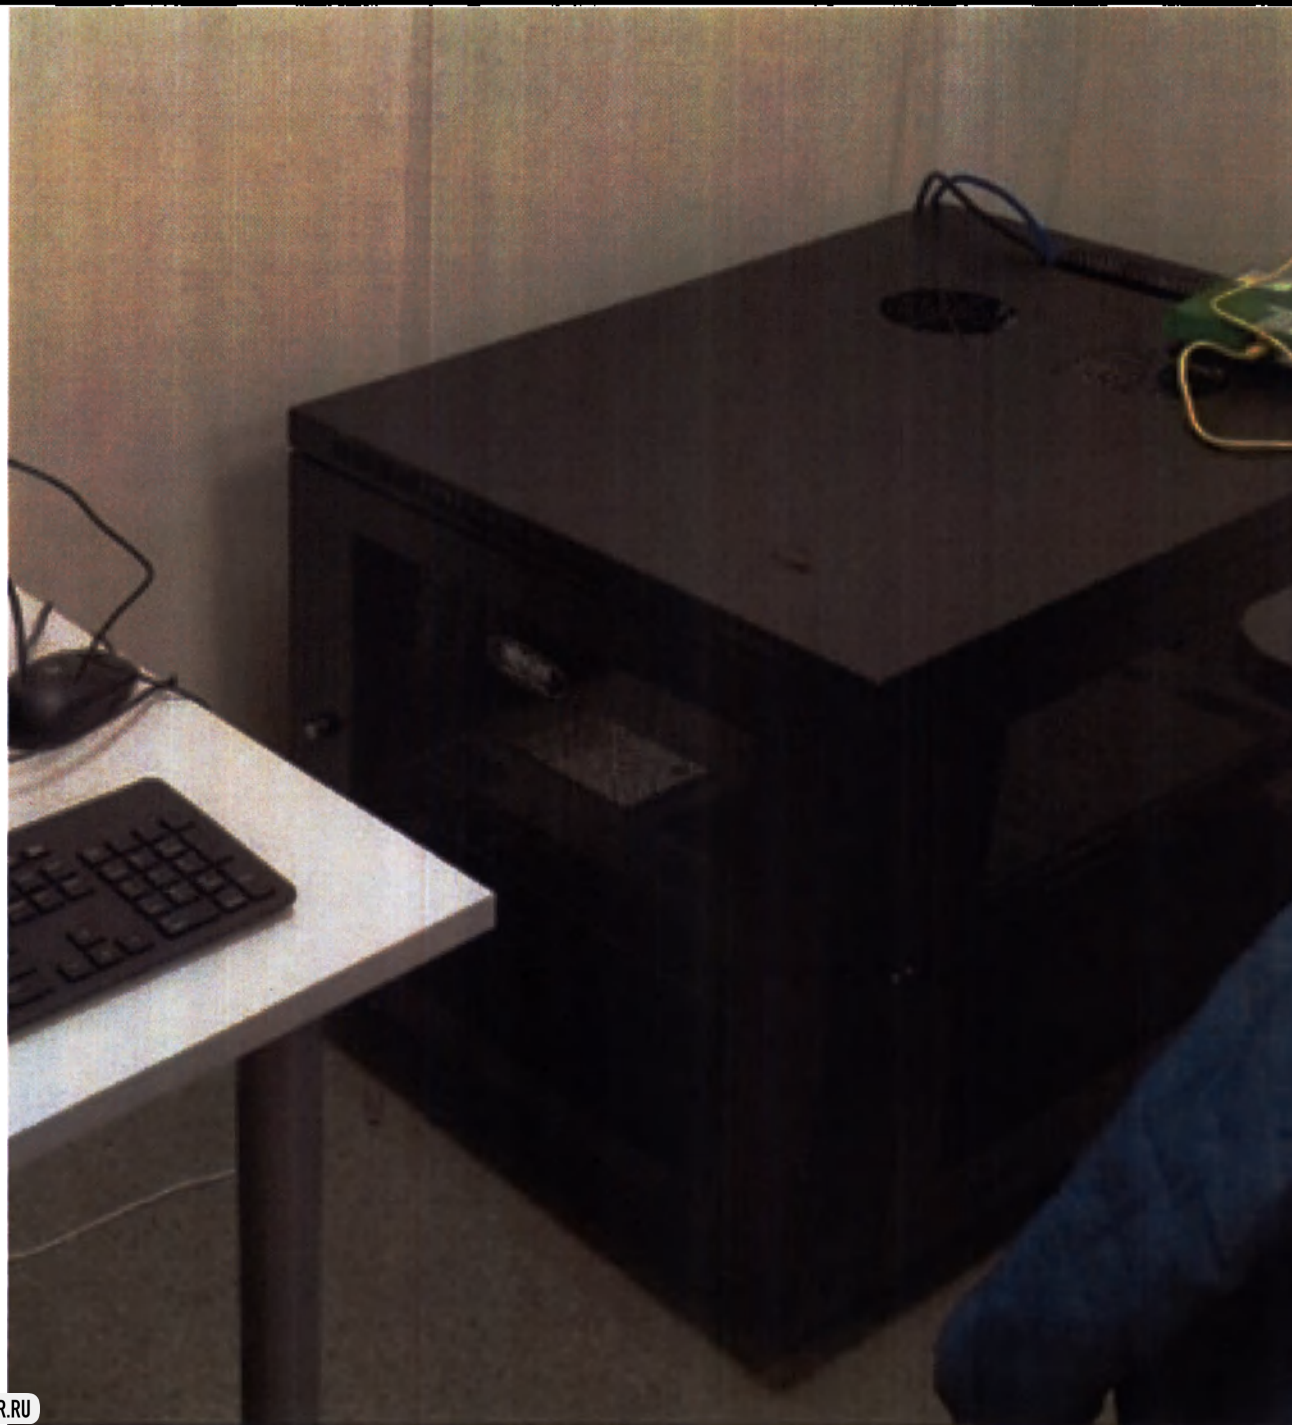

62. Серверные стойки (не более 5 шт.).

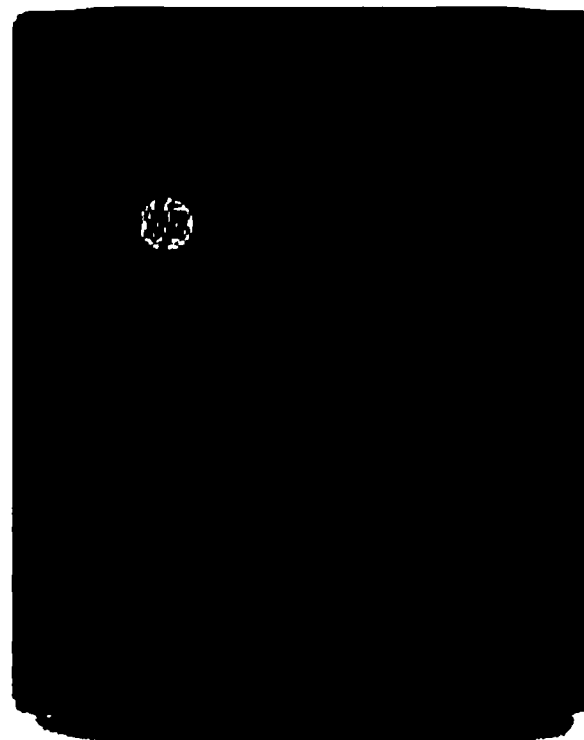


63. Держатели фантома (не более 5 шт.).

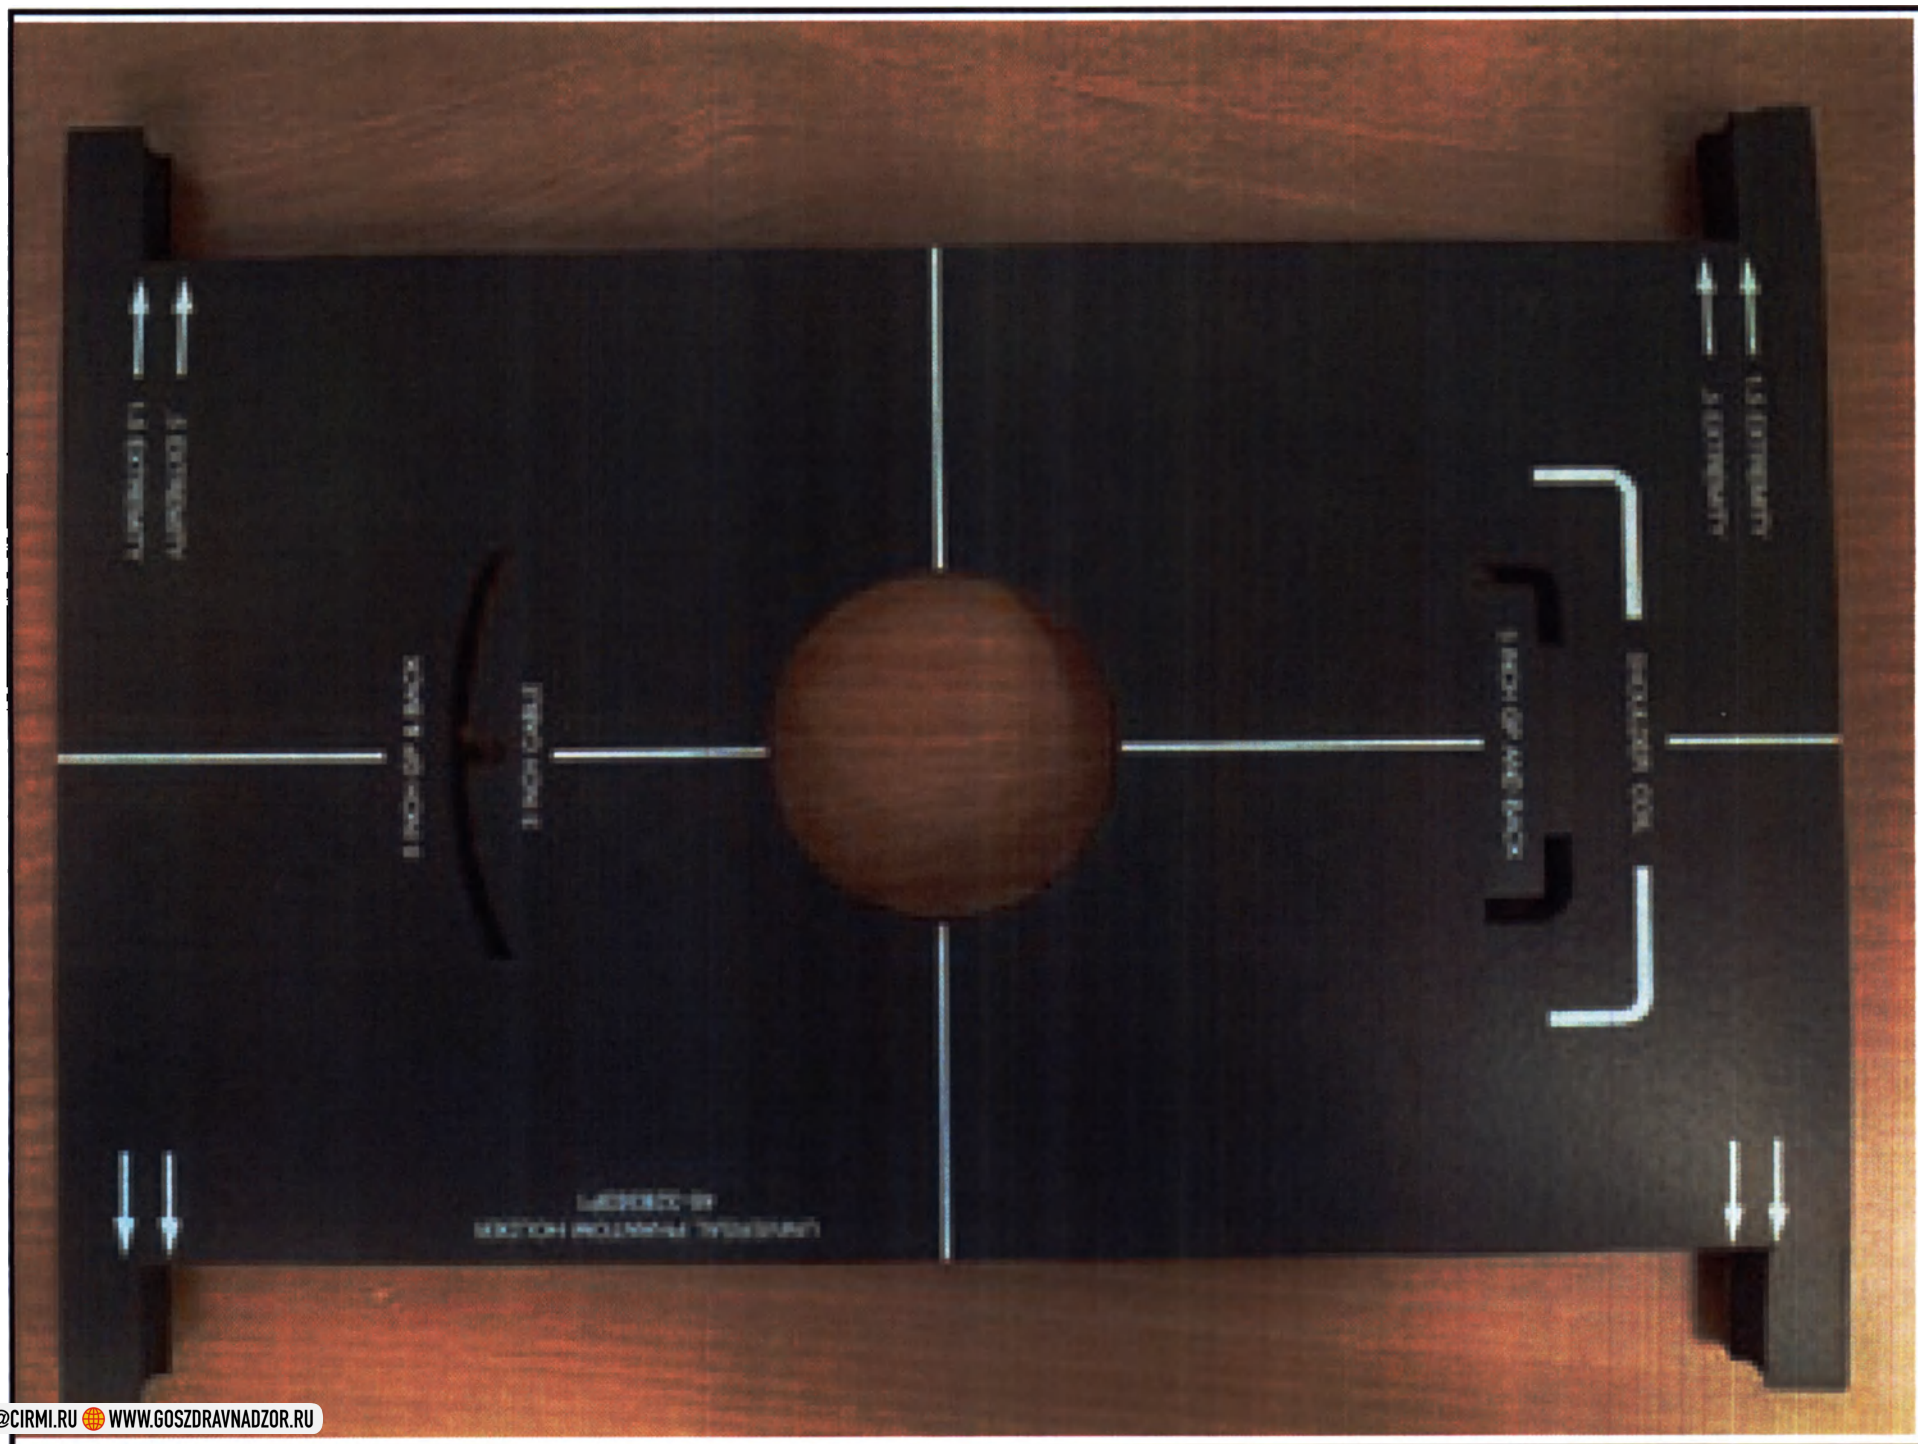


64. Адаптеры для краев трубы вертикальные (не более 10 шт.).



64. Адаптеры для квенч трубы вертикальные (не более 10 шт.).

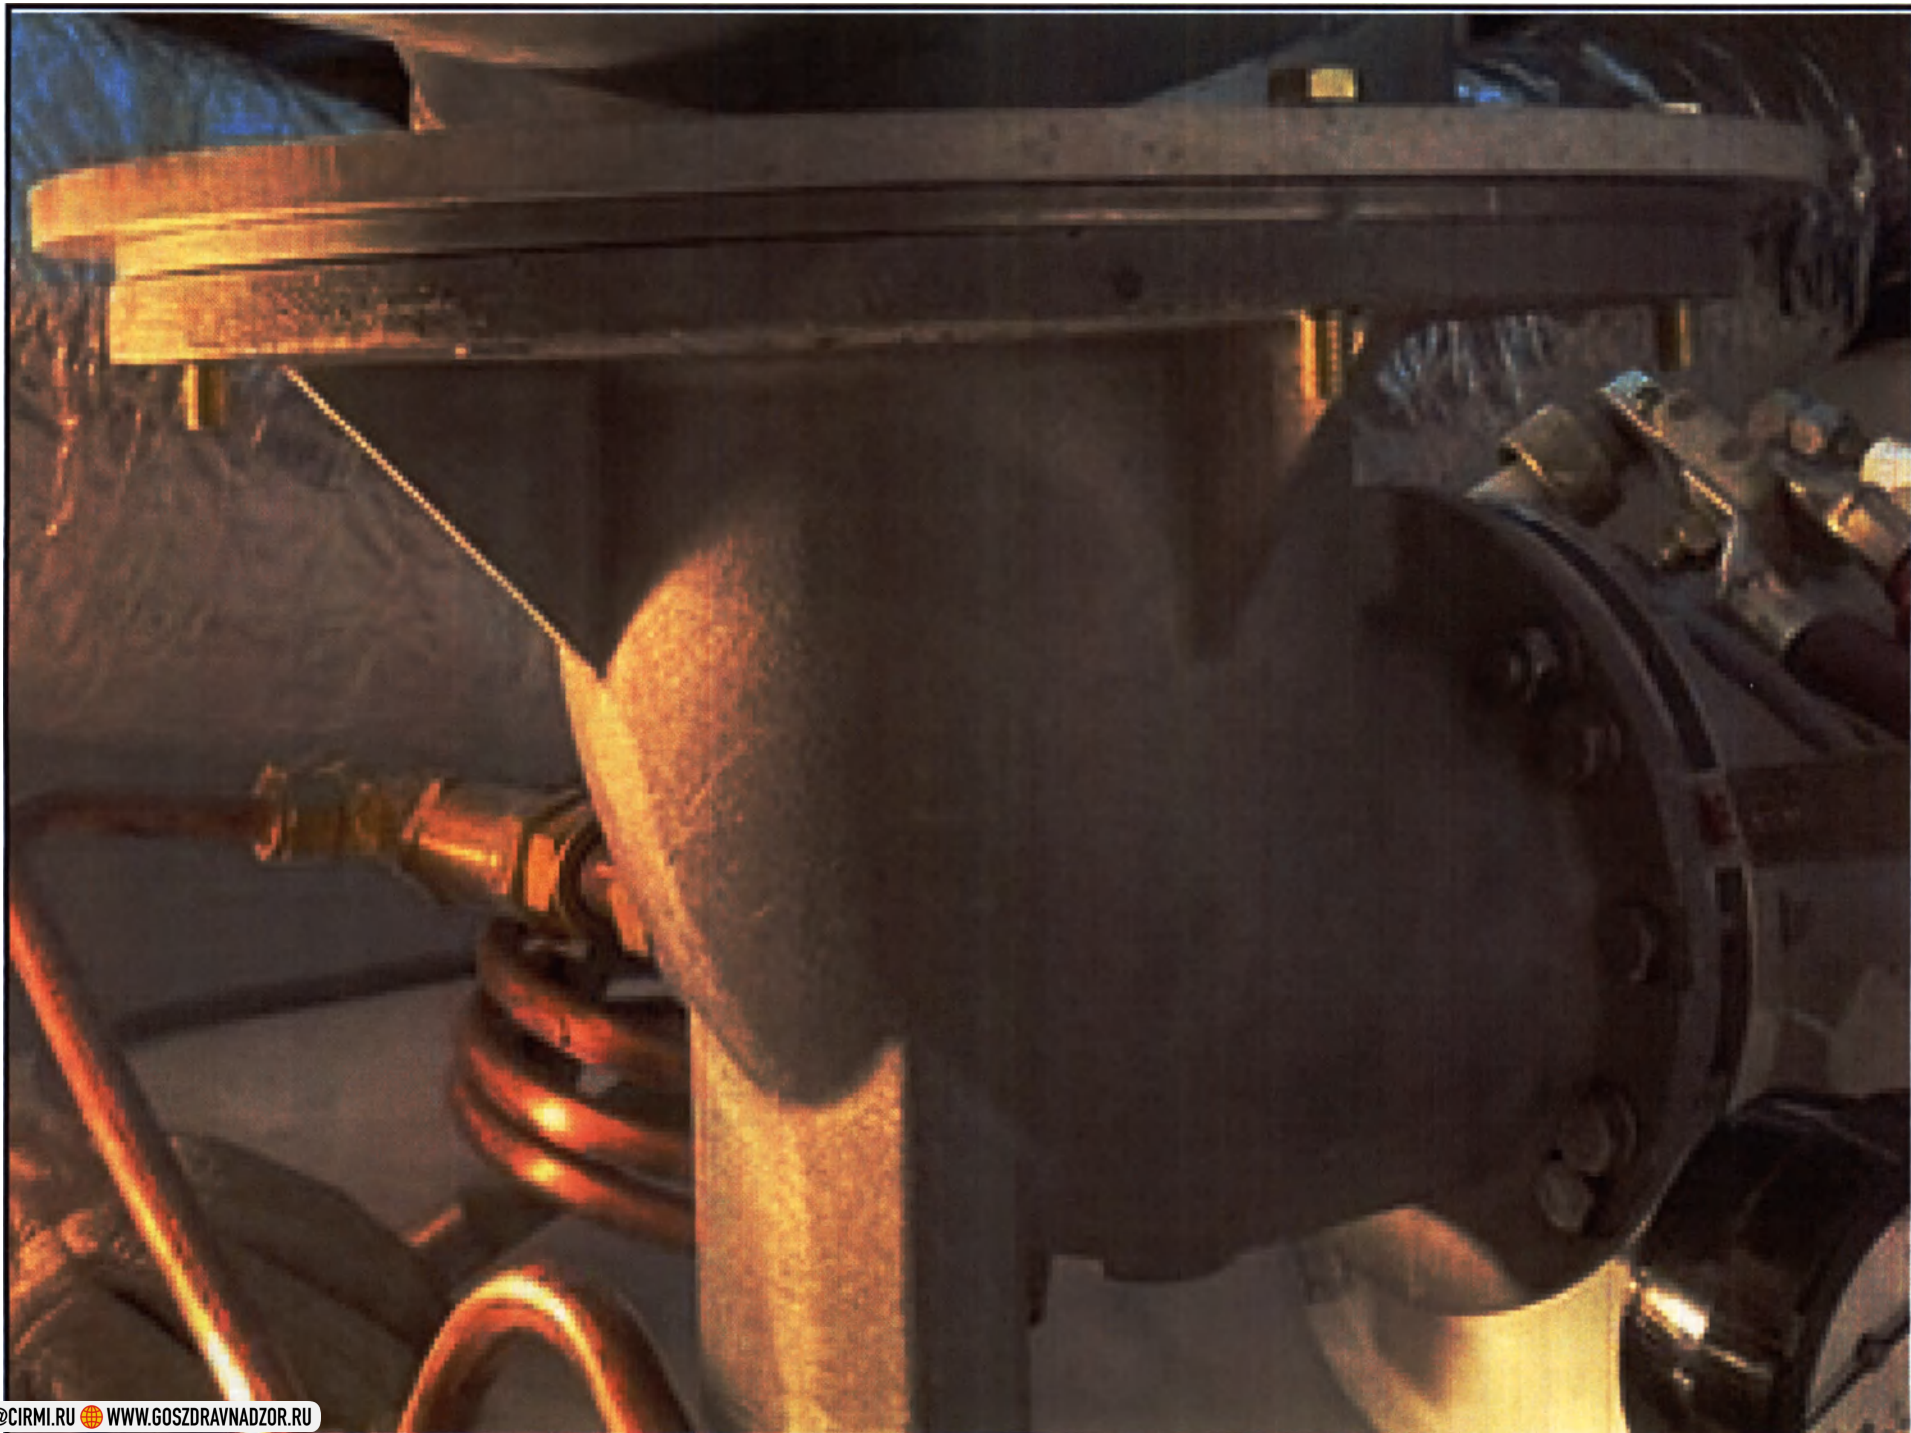

65. Инфузионная стойка.

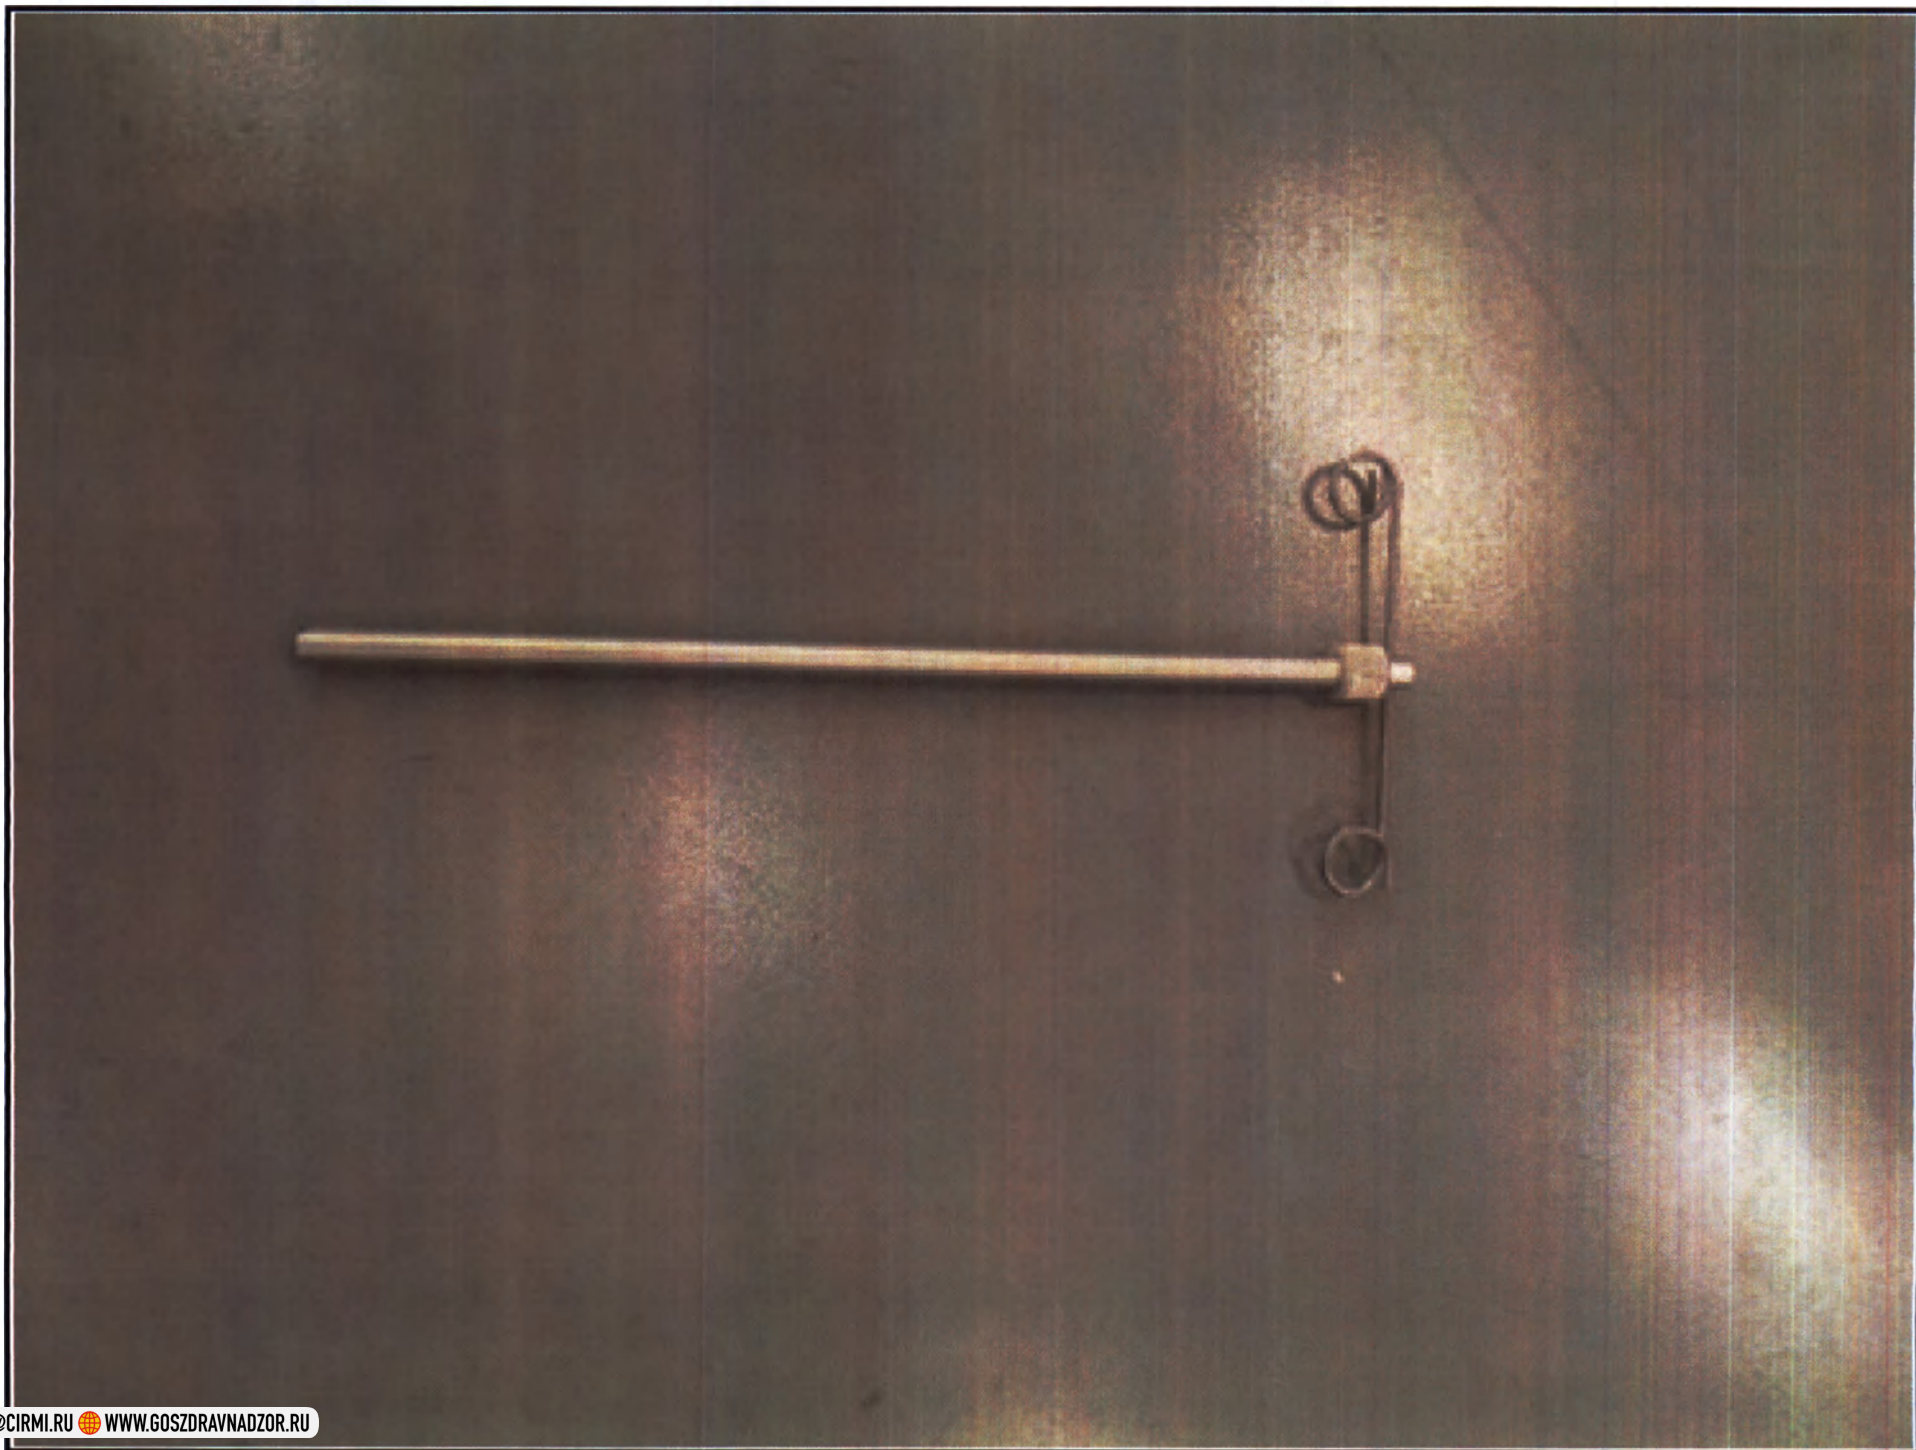

66. Крепления томографа в мобильный модуль (не более 50 шт.).



ПРОШЕТО И СЕРЕЖЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ *288* ЛИСТА(ОВ)

Shonitova

