

Генеральный директор

Викторов Н.В.

50231
Сентября 2021 г.



**«Ультразвуковой диагностический аппарат HM70A-RUS с принадлежностями,
варианты исполнения: HM70A-RUS, HM70A EXPERT-RUS, HM70 EVO-RUS »**

<i>Название принадлежности</i>	<i>№ страницы</i>
1. Электронная консоль с монитором	4
2. Сетевой кабель	5
3. Системный адаптер	6
4. Аккумуляторная батарея	7
5. Руководство пользователя	8
6. Датчик конвексный C2-6.....	9
7. Датчик конвексный CF4-9.....	10
8. Датчик конвексный EVN4-9.....	11
9. Датчик конвексный CA2-8AD.....	12
10. Датчик конвексный CA1-7AD.....	13
11. Датчик конвексный CA1-6A.....	14
12. Датчик конвексный VR5-9.....	15
13. Датчик конвексный E3-12A.....	16
14. Датчик конвексный EA2-11B.....	17
15. Датчик конвексный CA2-9AD (№ РЗН 2018/7390 от 19.07.2018)...	18
16. Датчик конвексный-монокристалльный SC1-6.....	19
17. Датчик линейный L4-7.....	20
18. Датчик линейный L5-13.....	21
19. Датчик линейный L7-16.....	22
20. Датчик линейный LA3-14AD.....	23
21. Датчик линейный LA3-19B.....	24
22. Датчик линейный LA3-16AD.....	25
23. Датчик линейный LS3-14B (№ РЗН 2019/8227 от 22.03.2019).....	26
24. Датчик линейный LS6-15 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017).....	27
25. Датчик фазированный PE2-4.....	28
26. Датчик фазированный P3-8.....	29
27. Датчик фазированный MMPT3-7.....	30
28. Датчик фазированный P4-12 (№ РЗН 2015/3259 от 28.10.2015)....	31
29. Датчик объемный VN4-8.....	32
30. Датчик объемный 3D4-8.....	33
31. Датчик объемный CV1-8AD.....	34
32. Датчик объемный V5-9.....	35
33. Датчик постоянно-волновой CW 2.0.....	36
34. Датчик постоянно-волновой CW4.0.....	37

35. Датчик постоянно-волновой CW6.0.....	38
36. Датчик постоянно-волновой DP2B.....	39
37. Датчик конвексный C2-8 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017).....	40
38. Датчик линейный LN5-12 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017).....	41
39. Датчик фазированный PN2-4 (№ РЗН 2020/11652 от 11/08/2020)....	43
40. Датчик фазированный SP3-8 (№ РЗН 2020/10698 от 11/06/2020)....	44
41. Набор для проведения биопсии , в составе: насадка для биопсии; направляющая иглы; крепление.....	45
42. Разветвитель для подключения дополнительных датчиков.....	46
43. Модуль ЭКГ	47
44. Приборная тележка	48
45. Стандартная мобильная тележка	49
46. Дополнительная аккумуляторная батарея	50
47. Соединительные провода и кабели	51
48. Ножной переключатель (№ РЗН 2015/3259 от 28.10.2015).....	52
49. Флеш-накопитель.....	53
50. Устройство видеовывода	54
51. Адаптер переменного тока	55
52. Соединитель	56
53. Генератор магнитного поля	57
54. Накладка силиконовая на клавиатуру (CP skin)	58
55. Сумка транспортировочная	59
56. Лицензионный ключ для активации функций.....	60
57. Маркировка изделия.....	61



Электронная консоль с монитором



Сетевой кабель



Системный адаптер



Аккумуляторная батарея

SAMSUNG

SAMSUNG MEDISON
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Версия 4.00

HM70A-RUS HM70A EXPERT-RUS HM70 EVO-RUS

Эксплуатационная документация производителя


Русский



Copyright © 2014 By SAMSUNG MEDISON CO., LTD. All rights reserved




Датчик конвексный С2-6

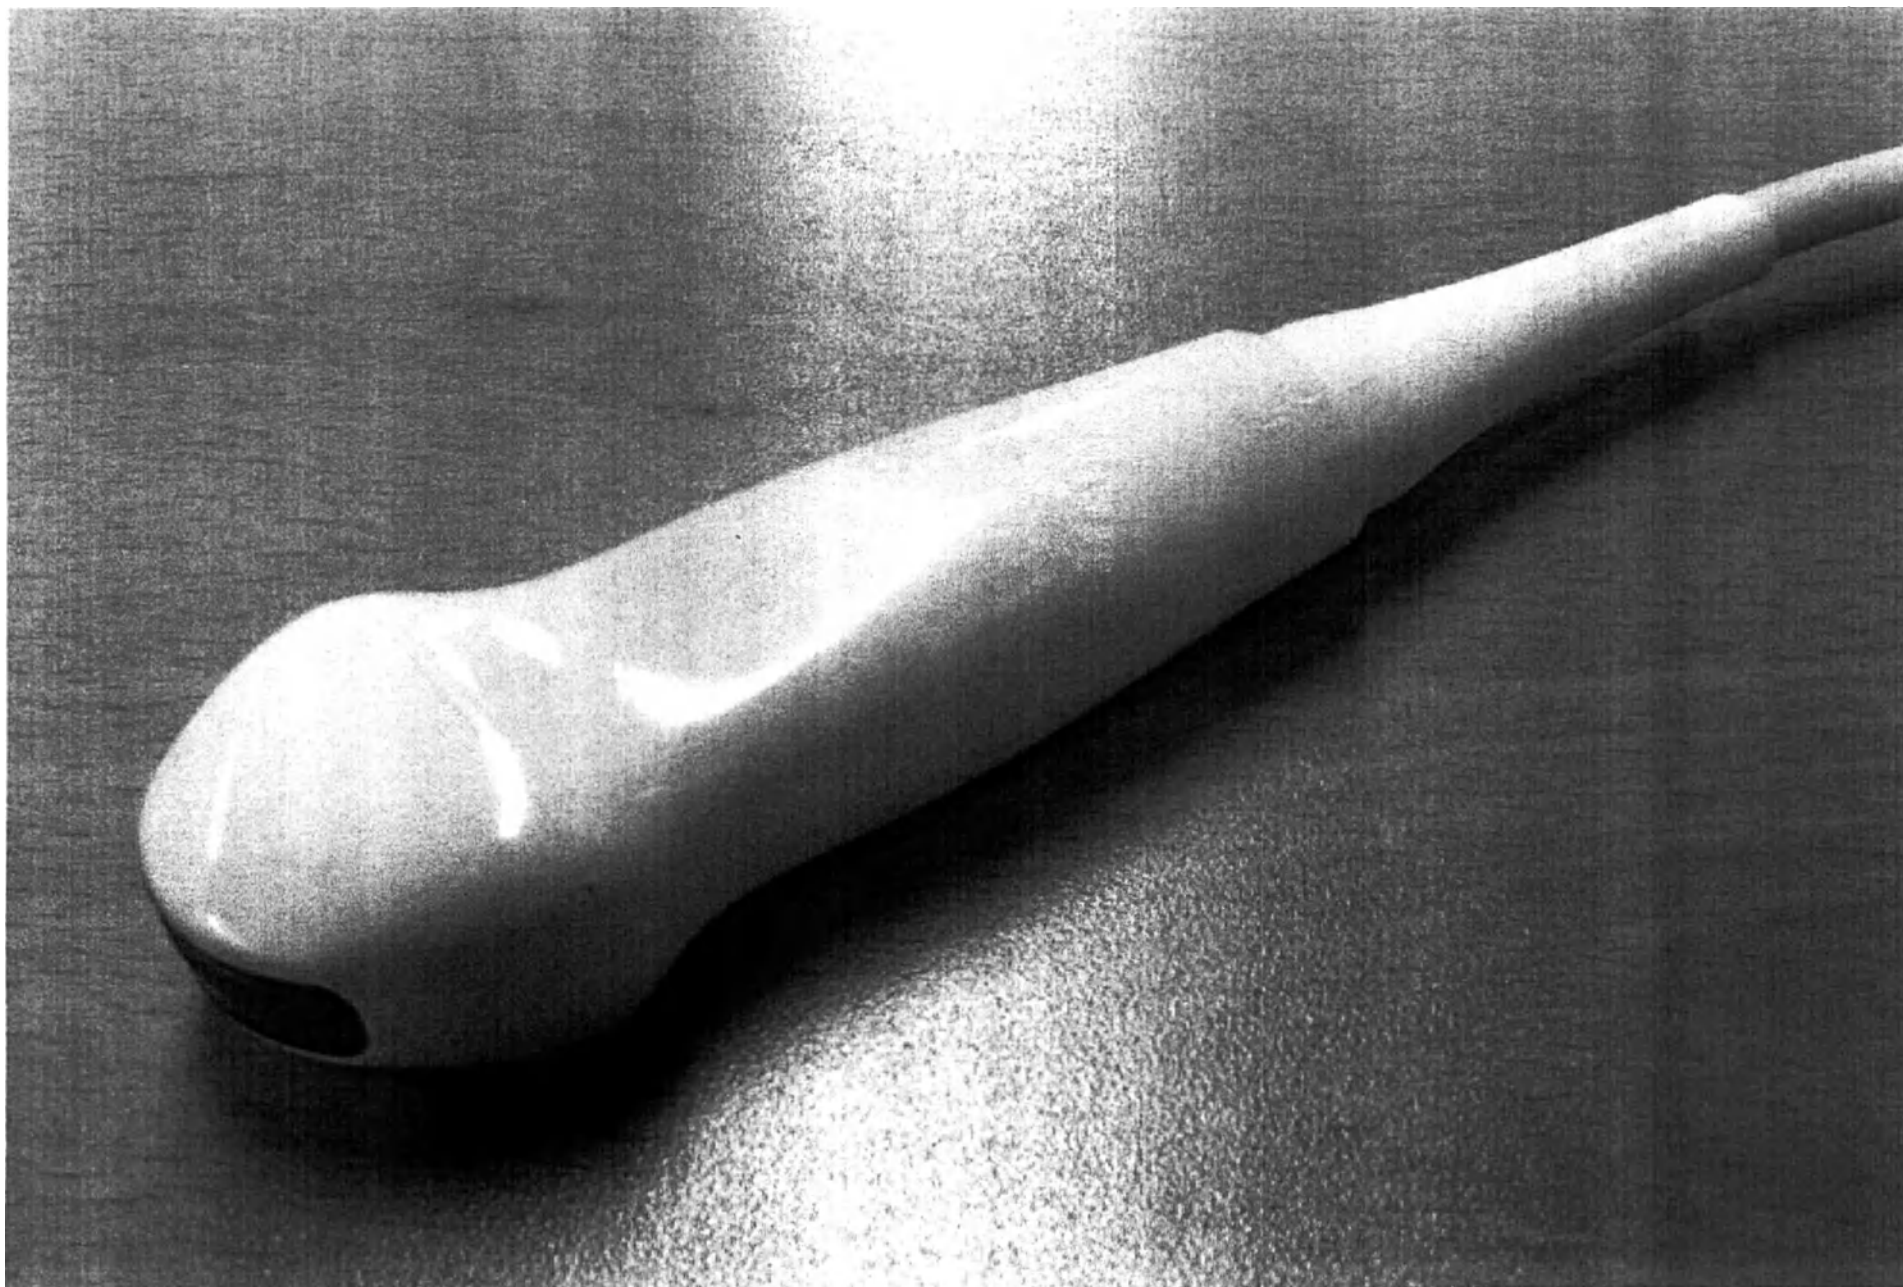


Датчик конвексный CF4-9




Датчик конвексный EVN4-9

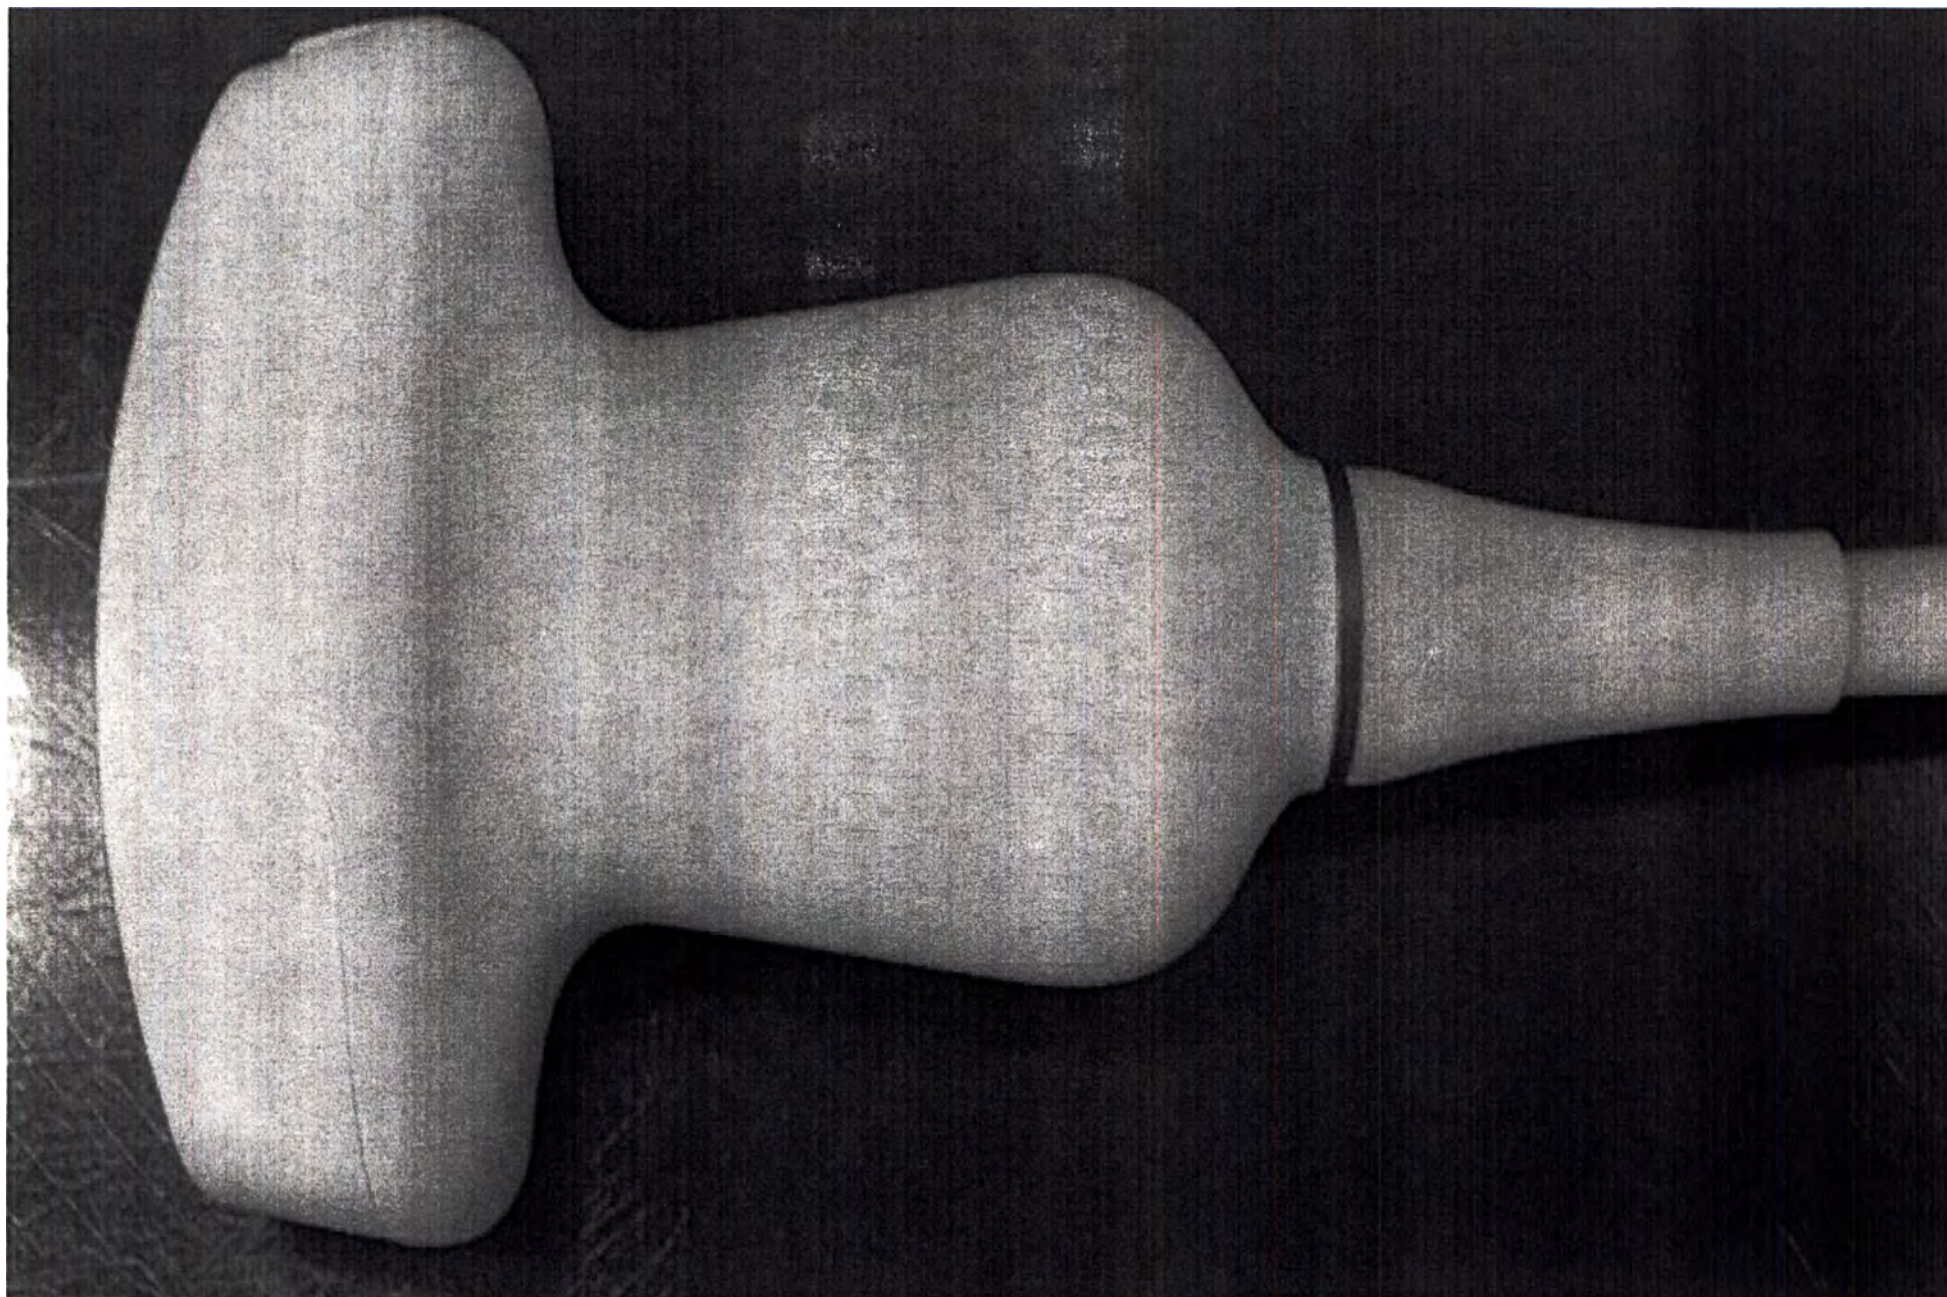


Датчик конвексный СА2-8АД

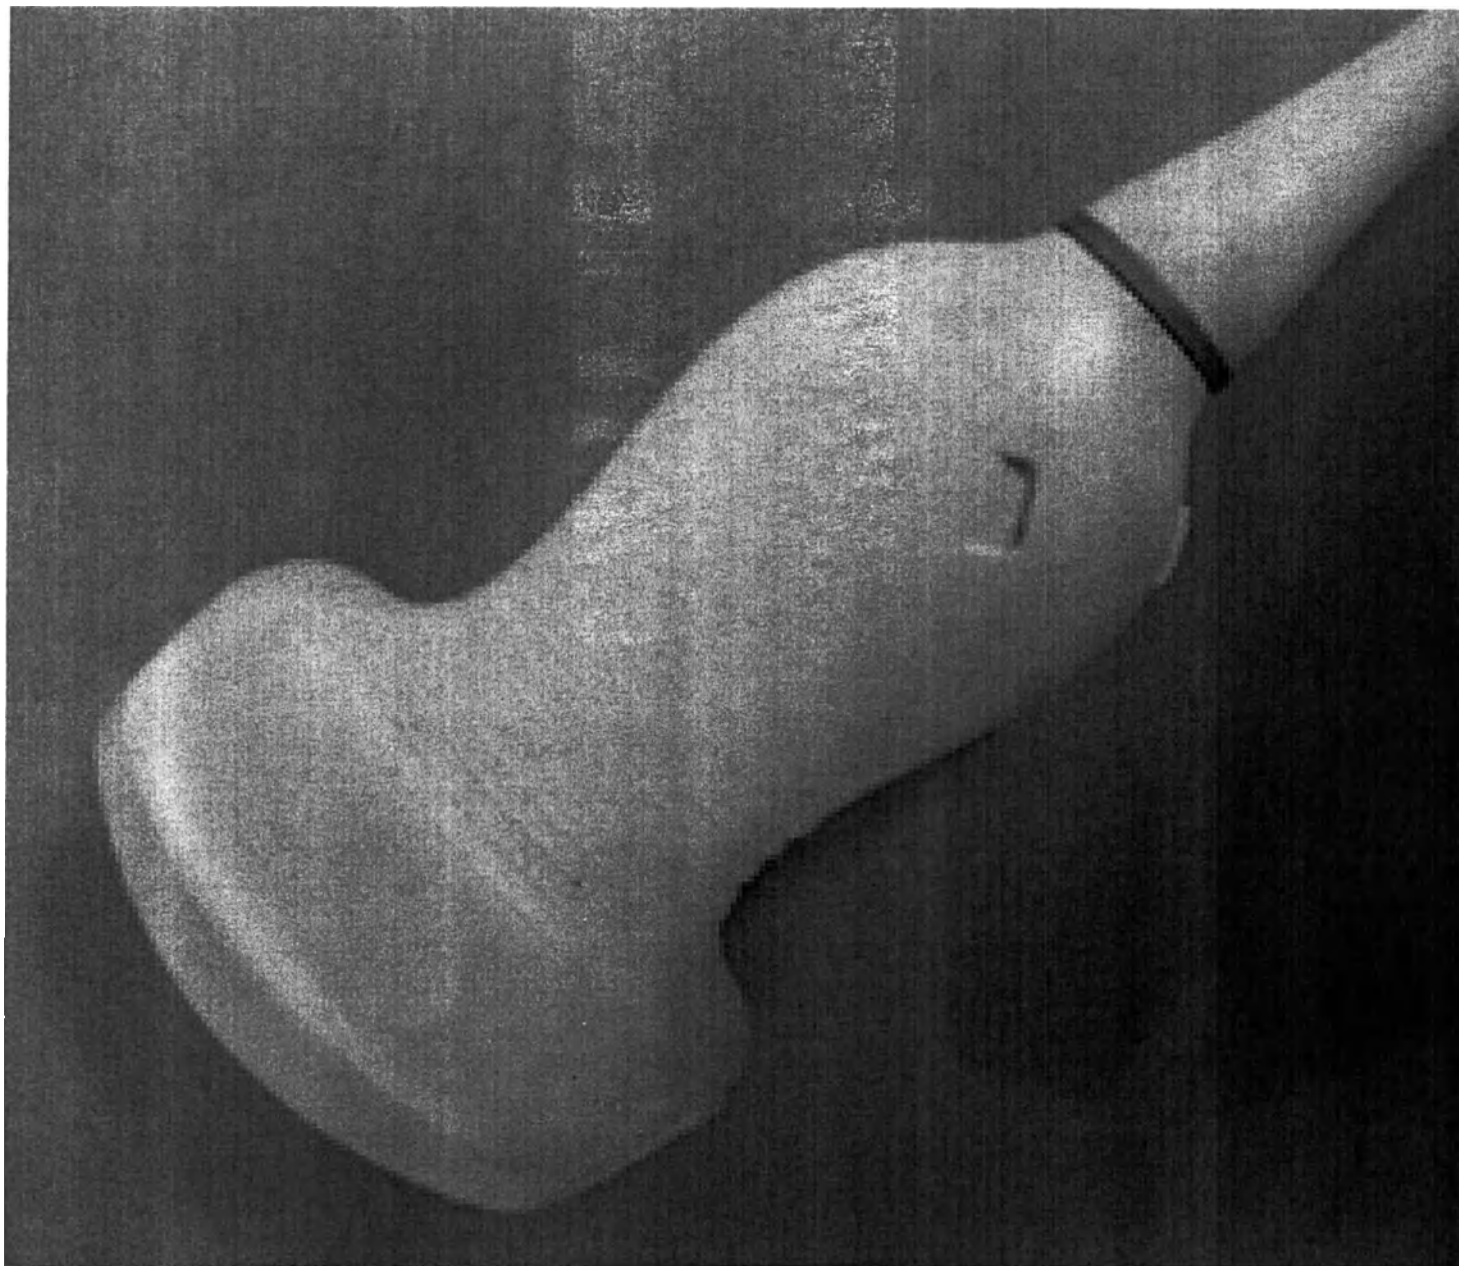


Датчик конвексный CA1-7AD

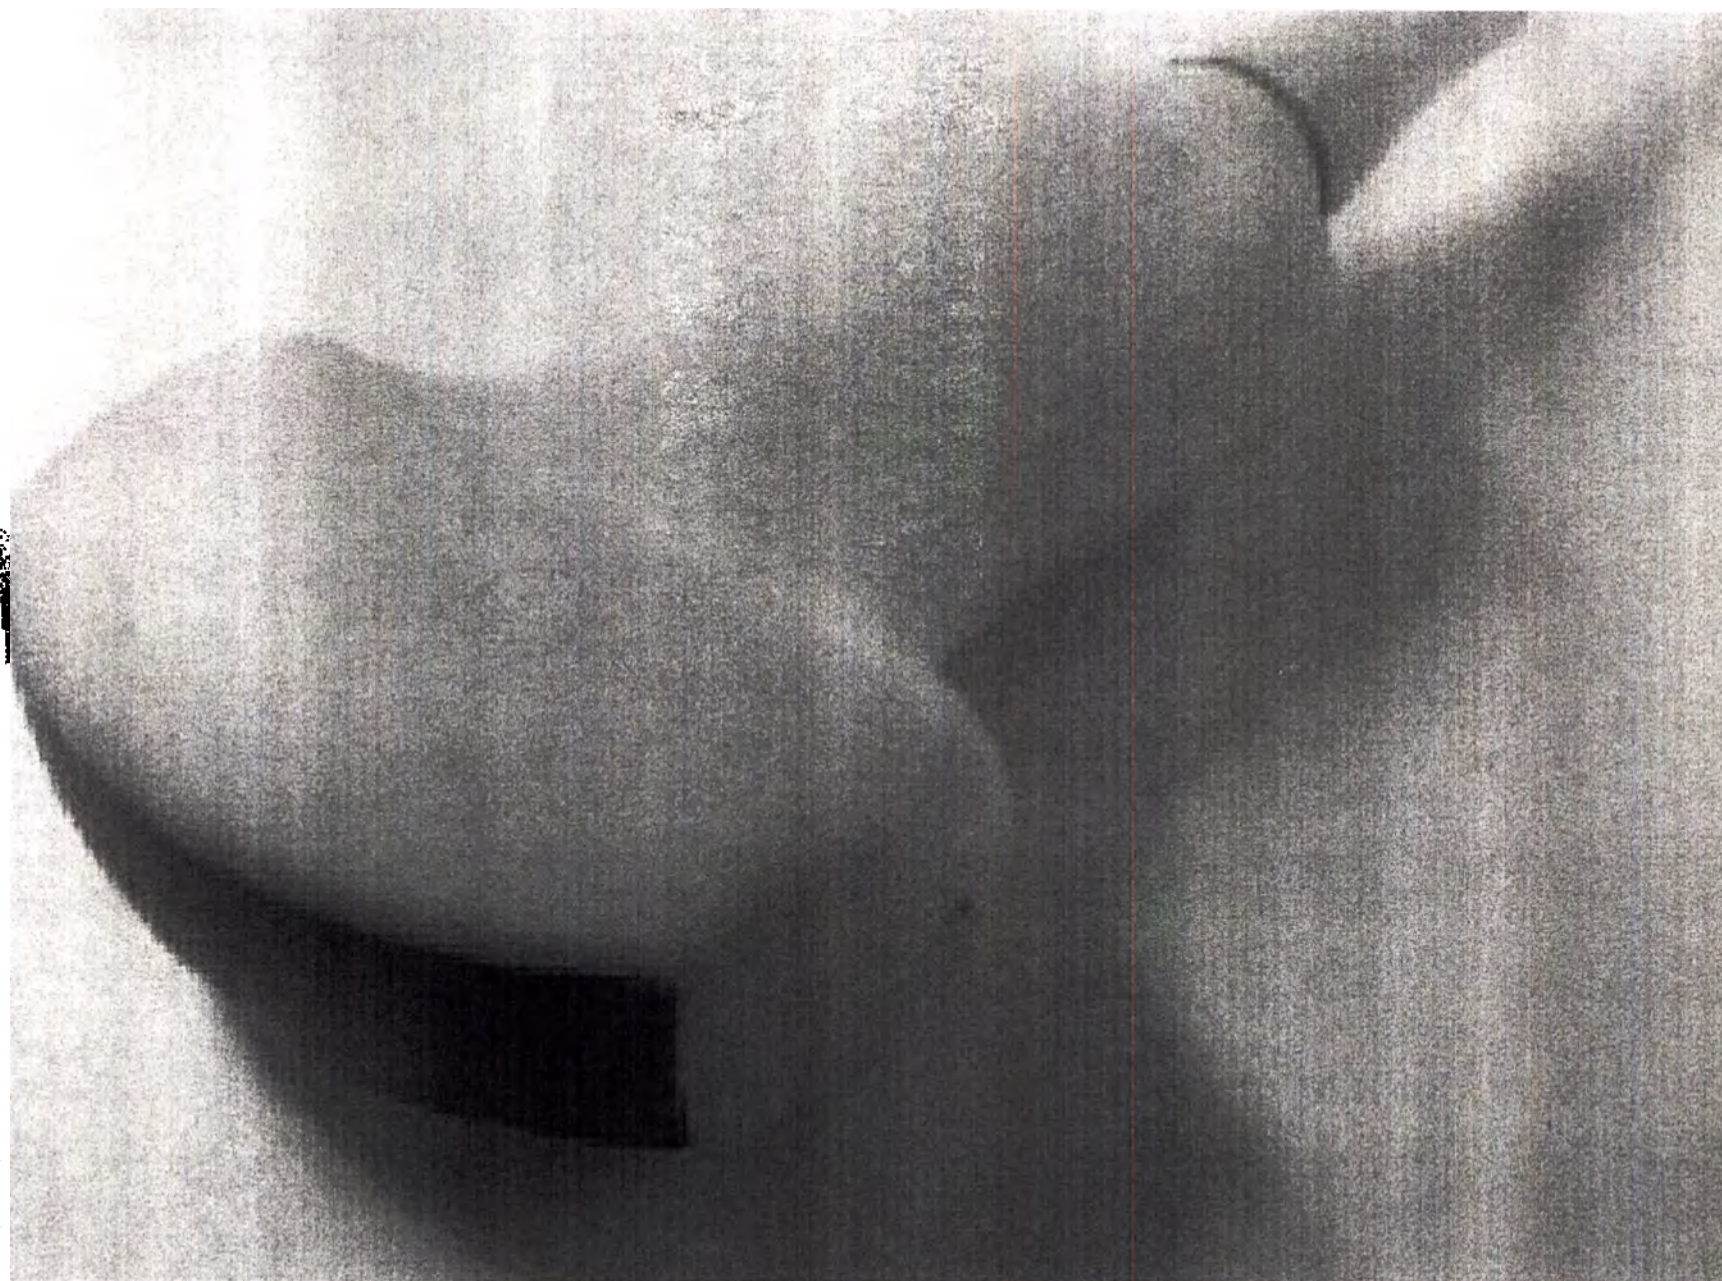


Датчик конвексный CA1-6A

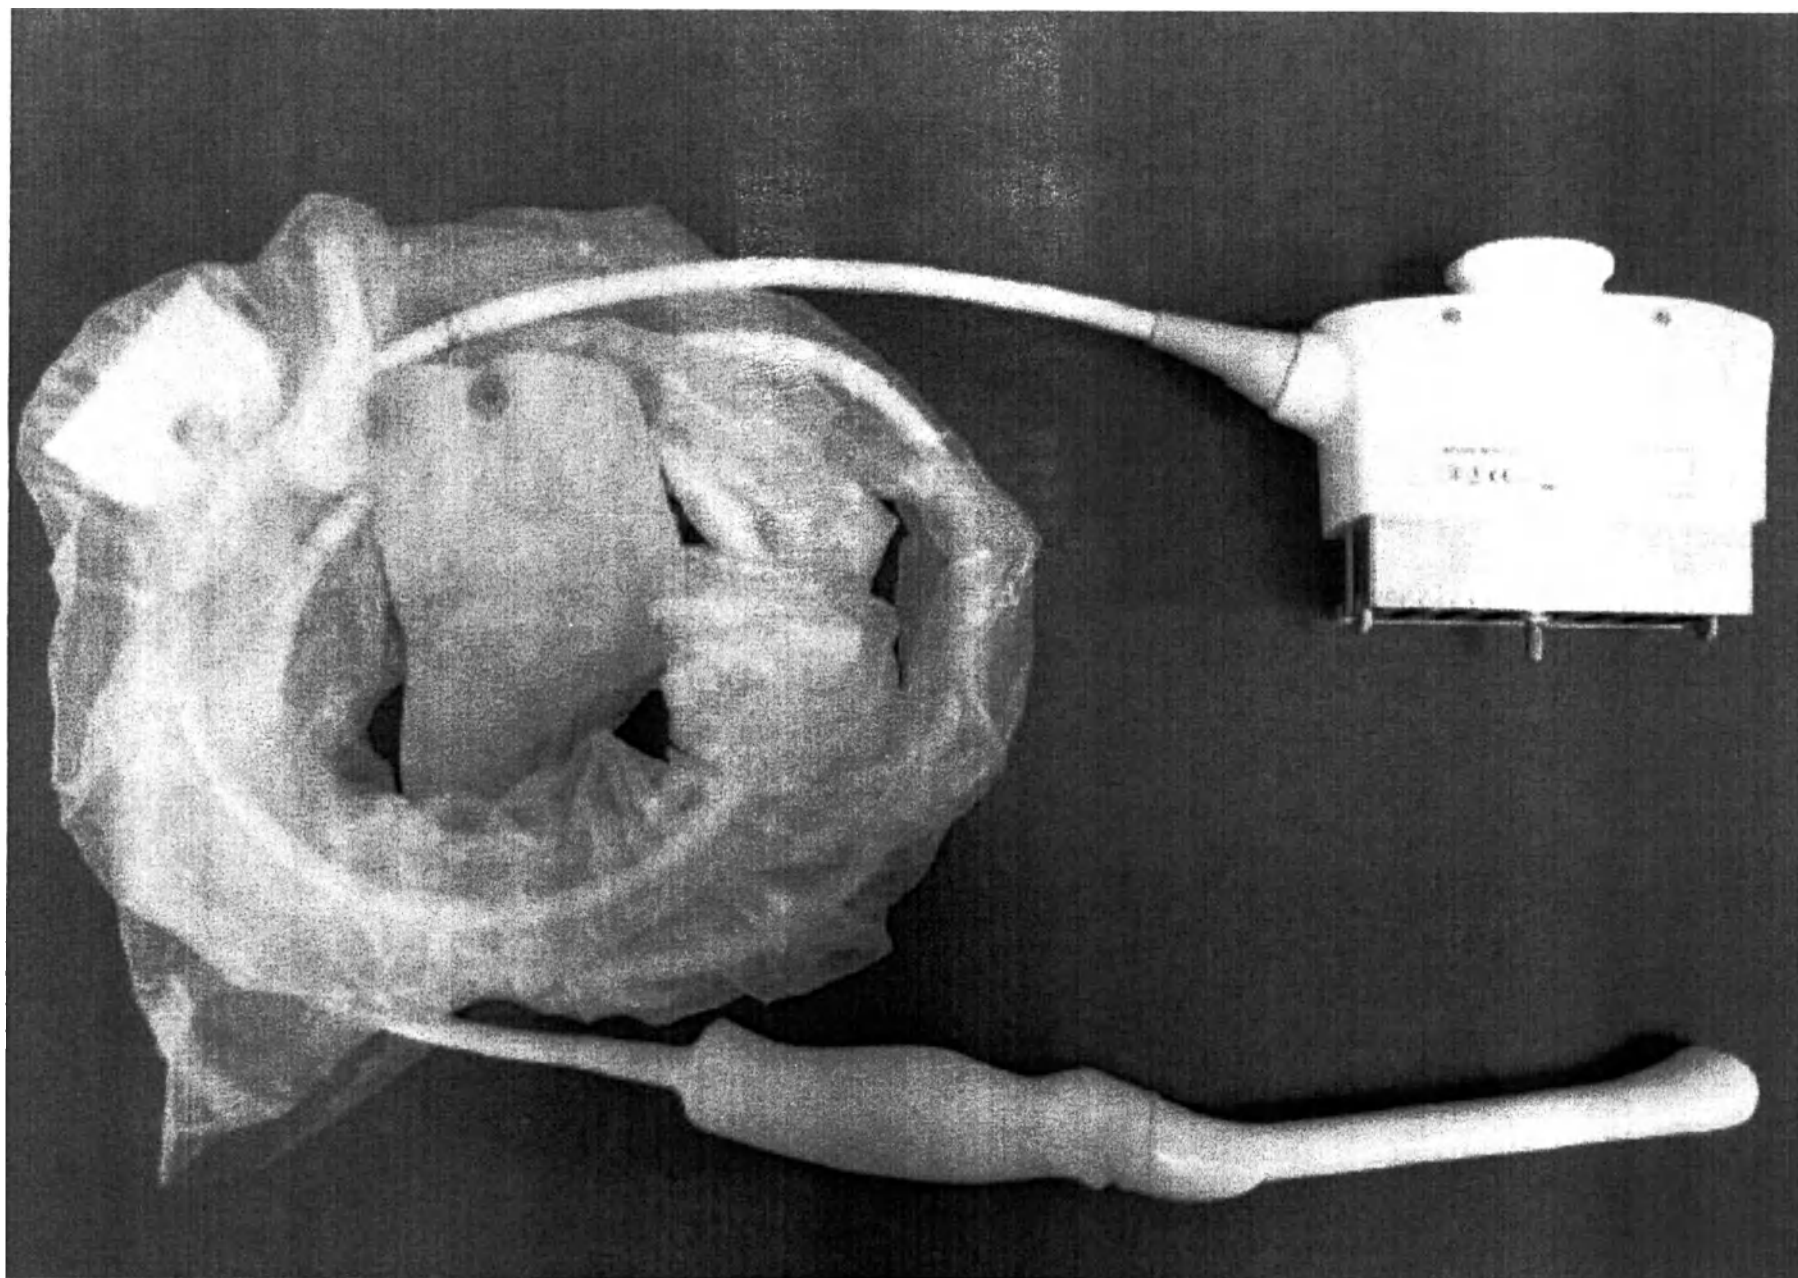

Датчик конвексный VR5-9

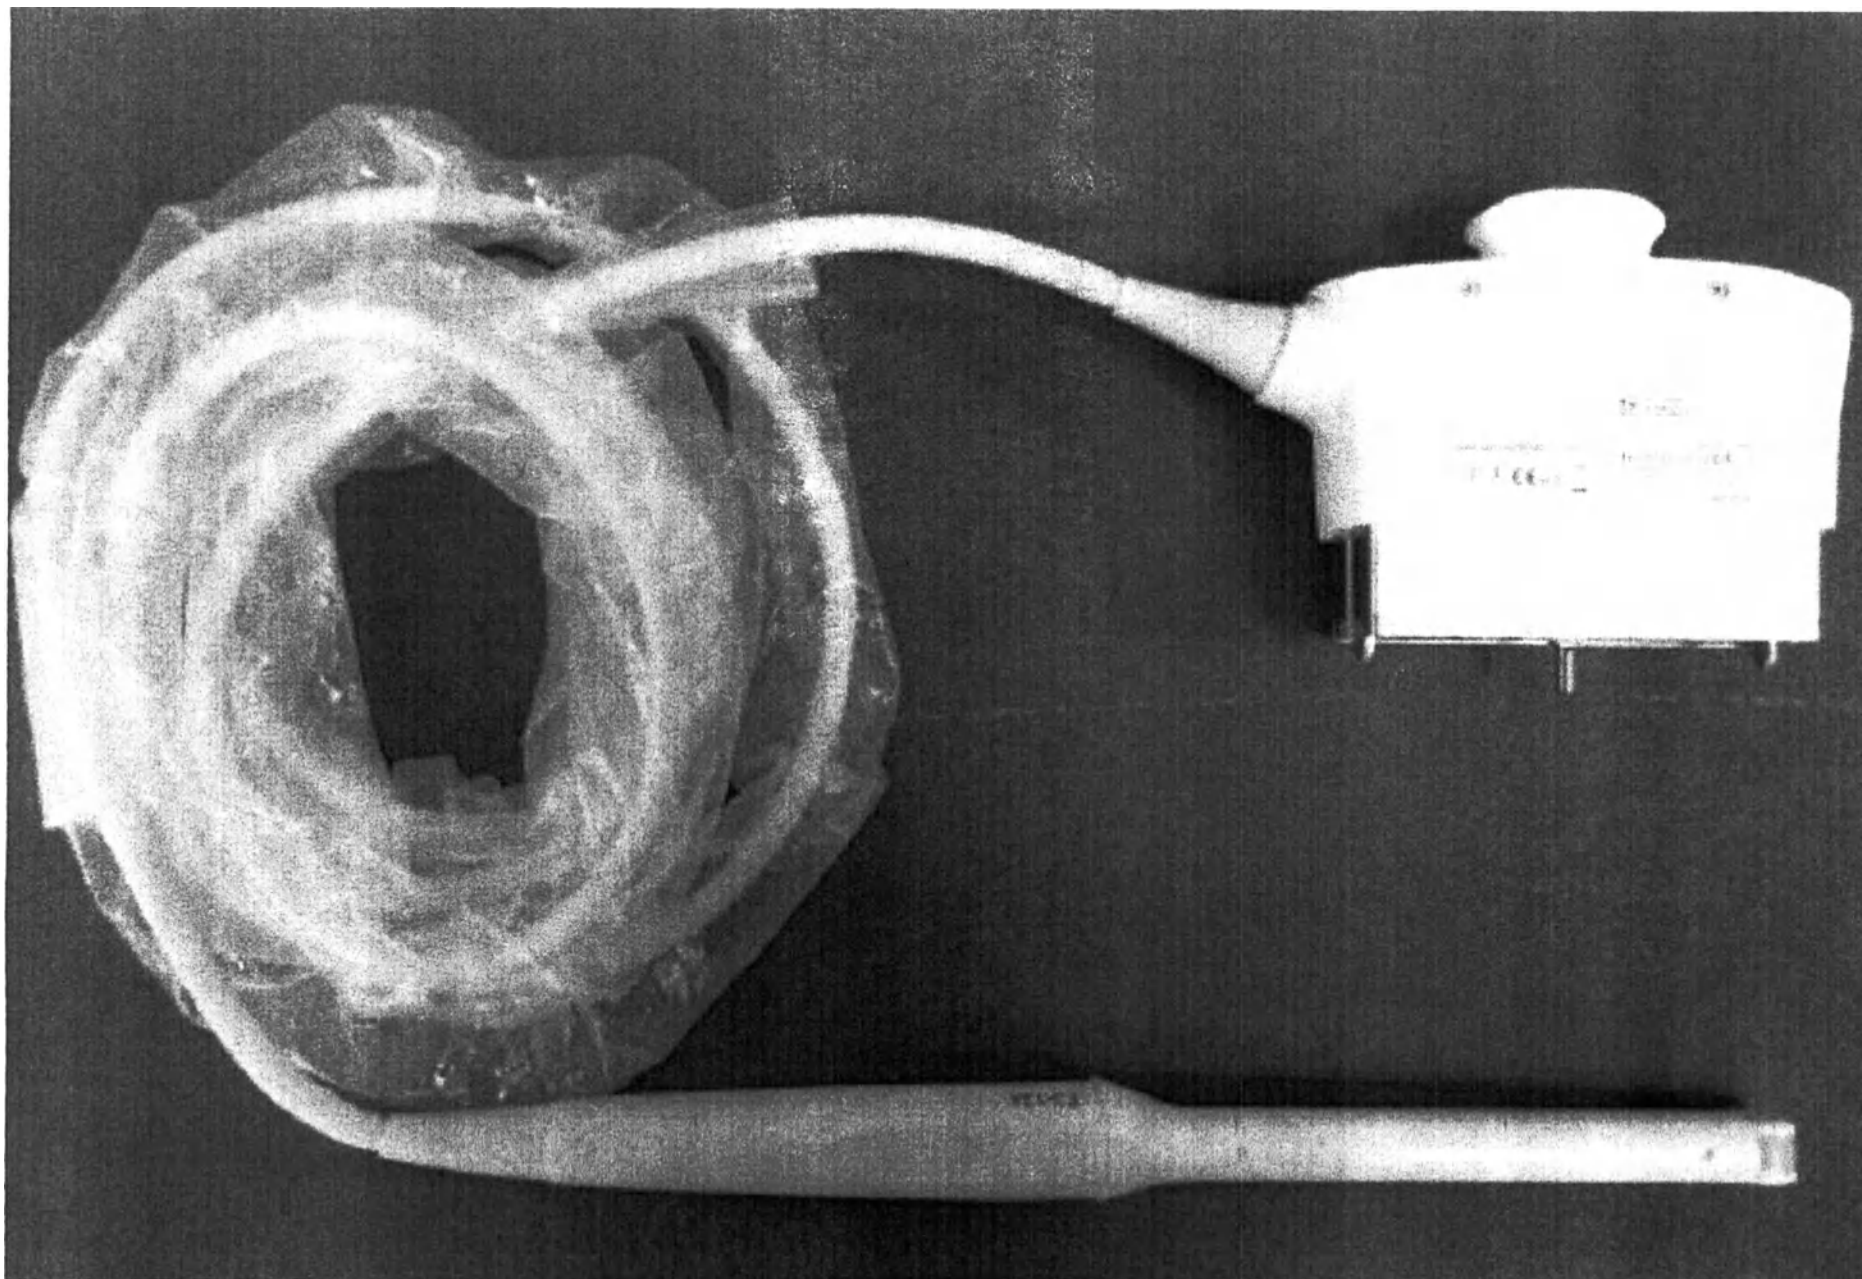

Датчик конвексный ЕЗ-12А

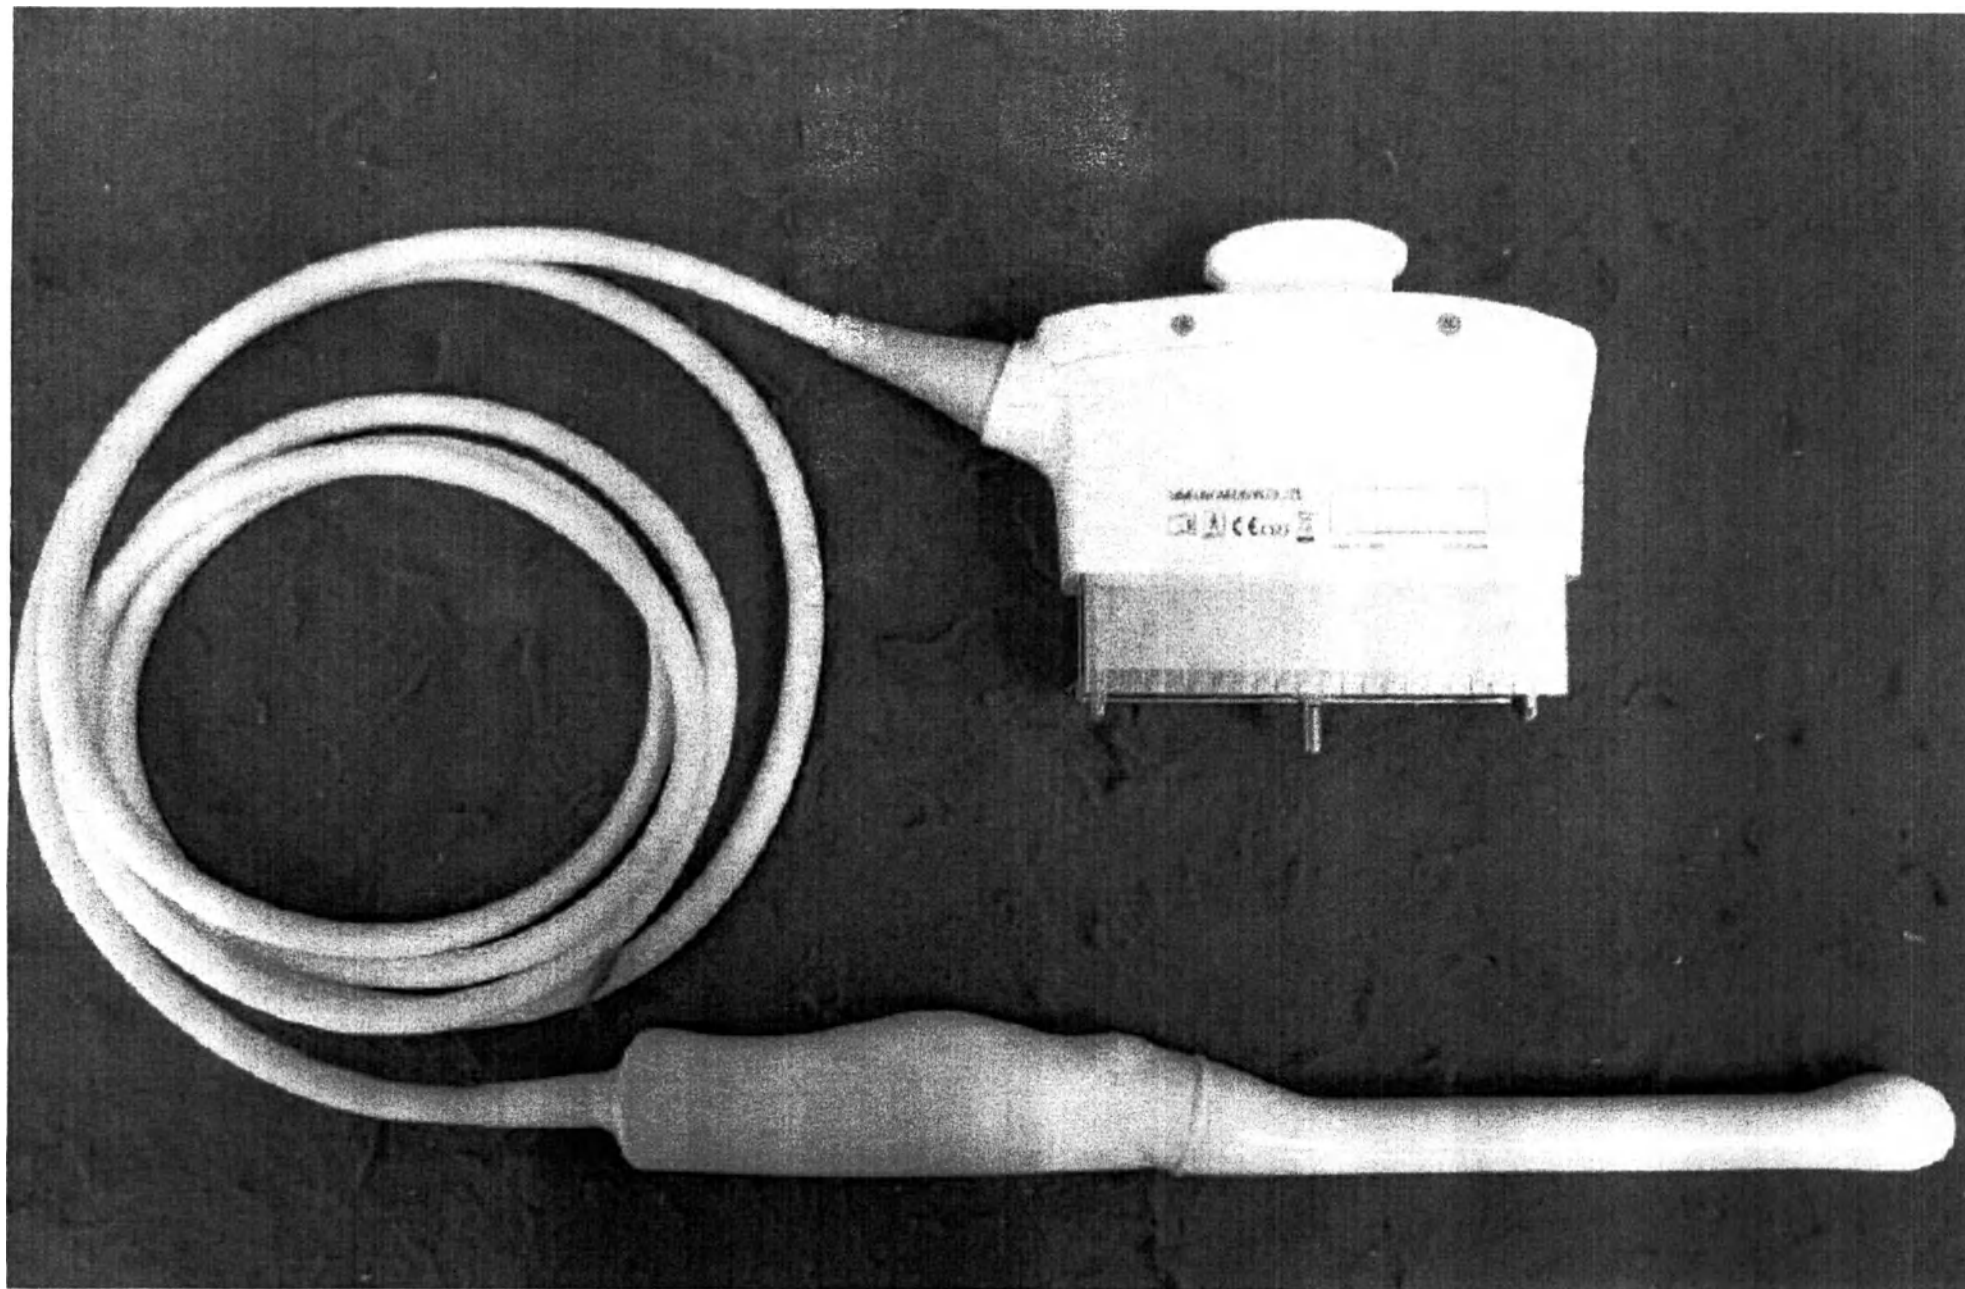

Датчик конвексный EA2-11B



Датчик конвексный CA2-9AD (№ РЗН 2018/7390 от 19.07.2018)




Датчик конвексный-монокристалльный SC1-6




Датчик линейный L4-7




Датчик линейный L5-13

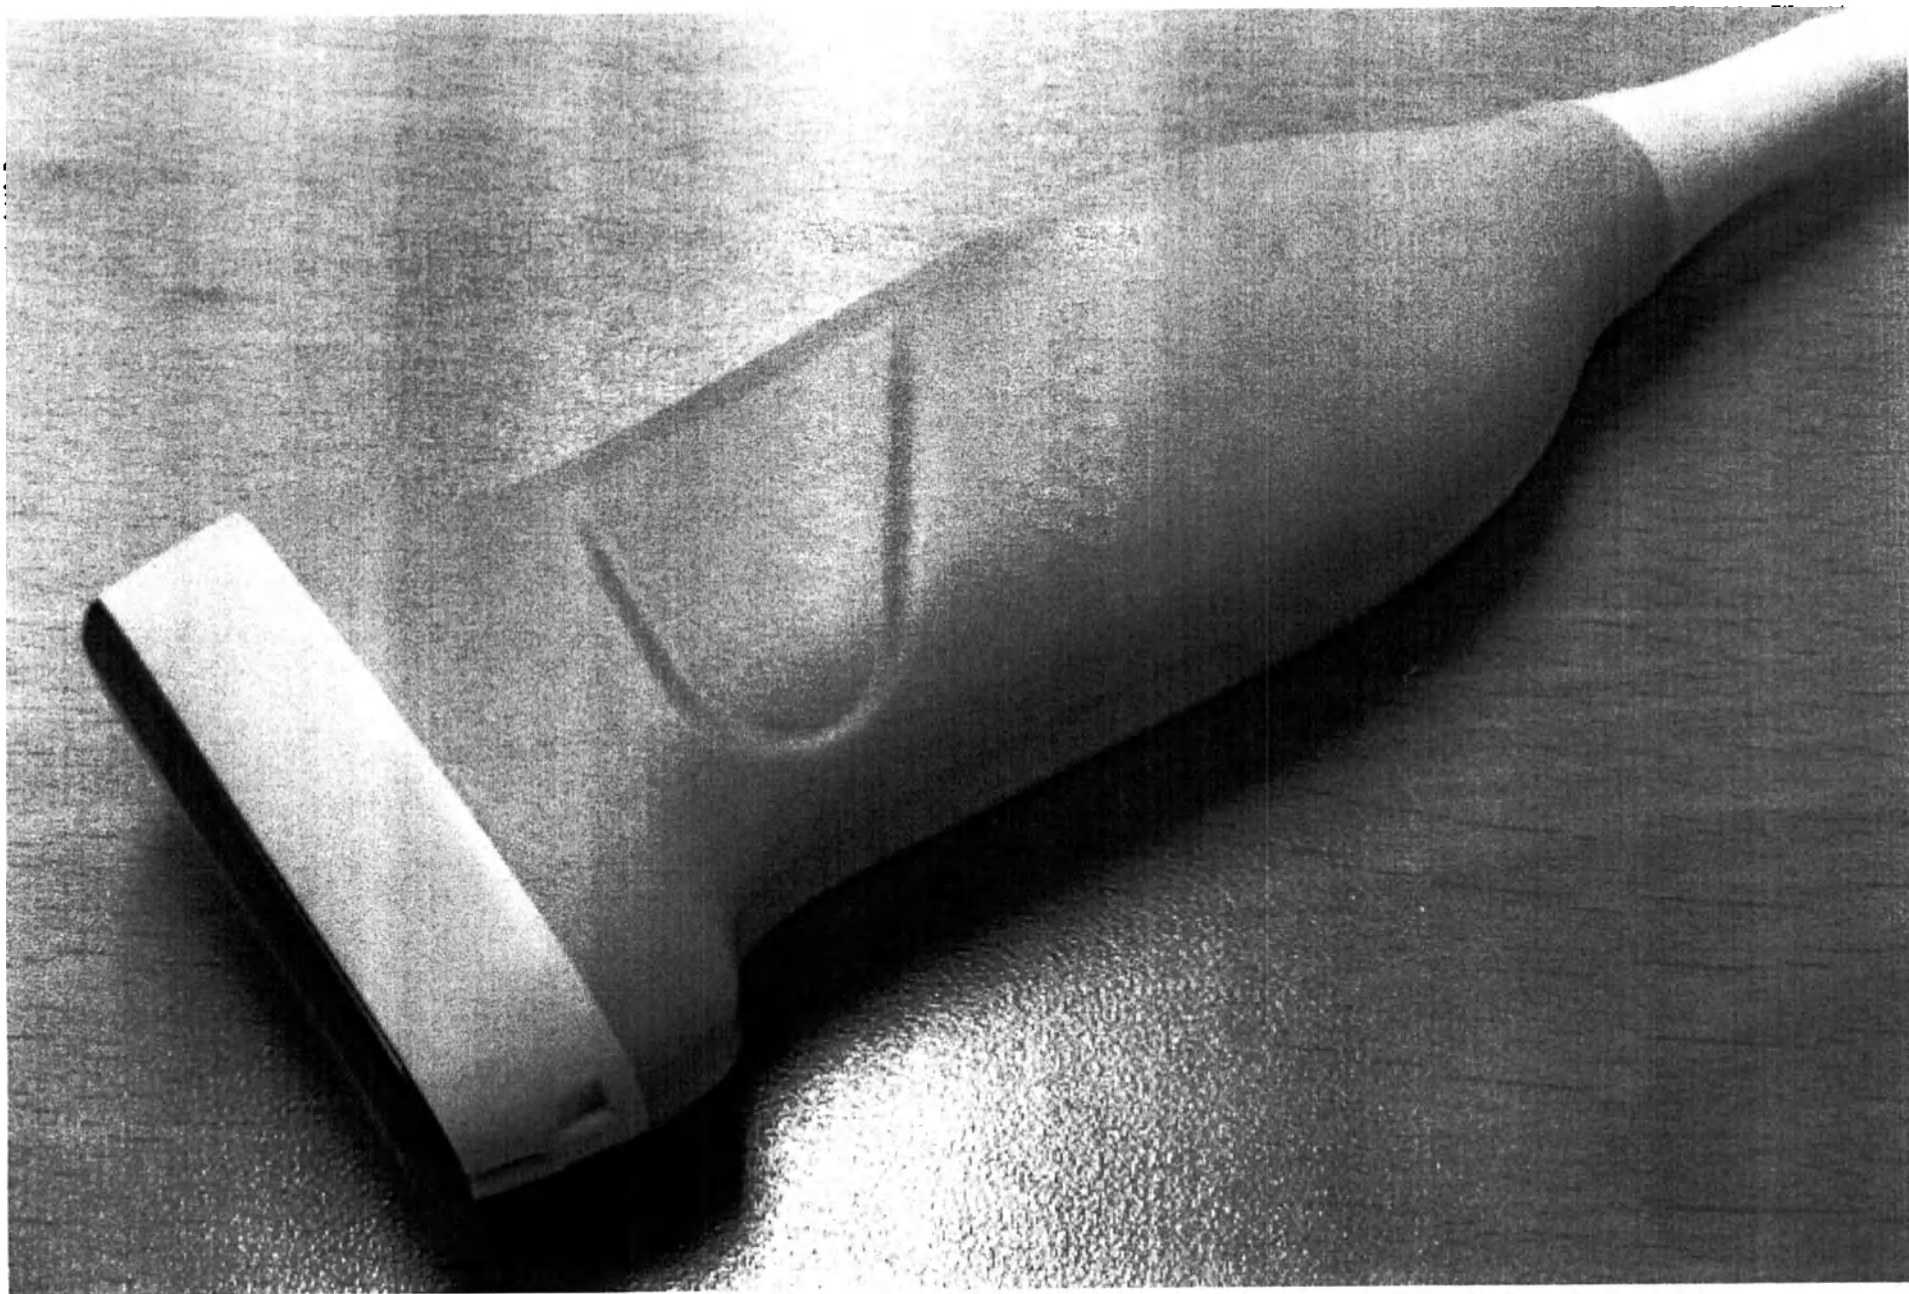


Датчик линейный L7-16

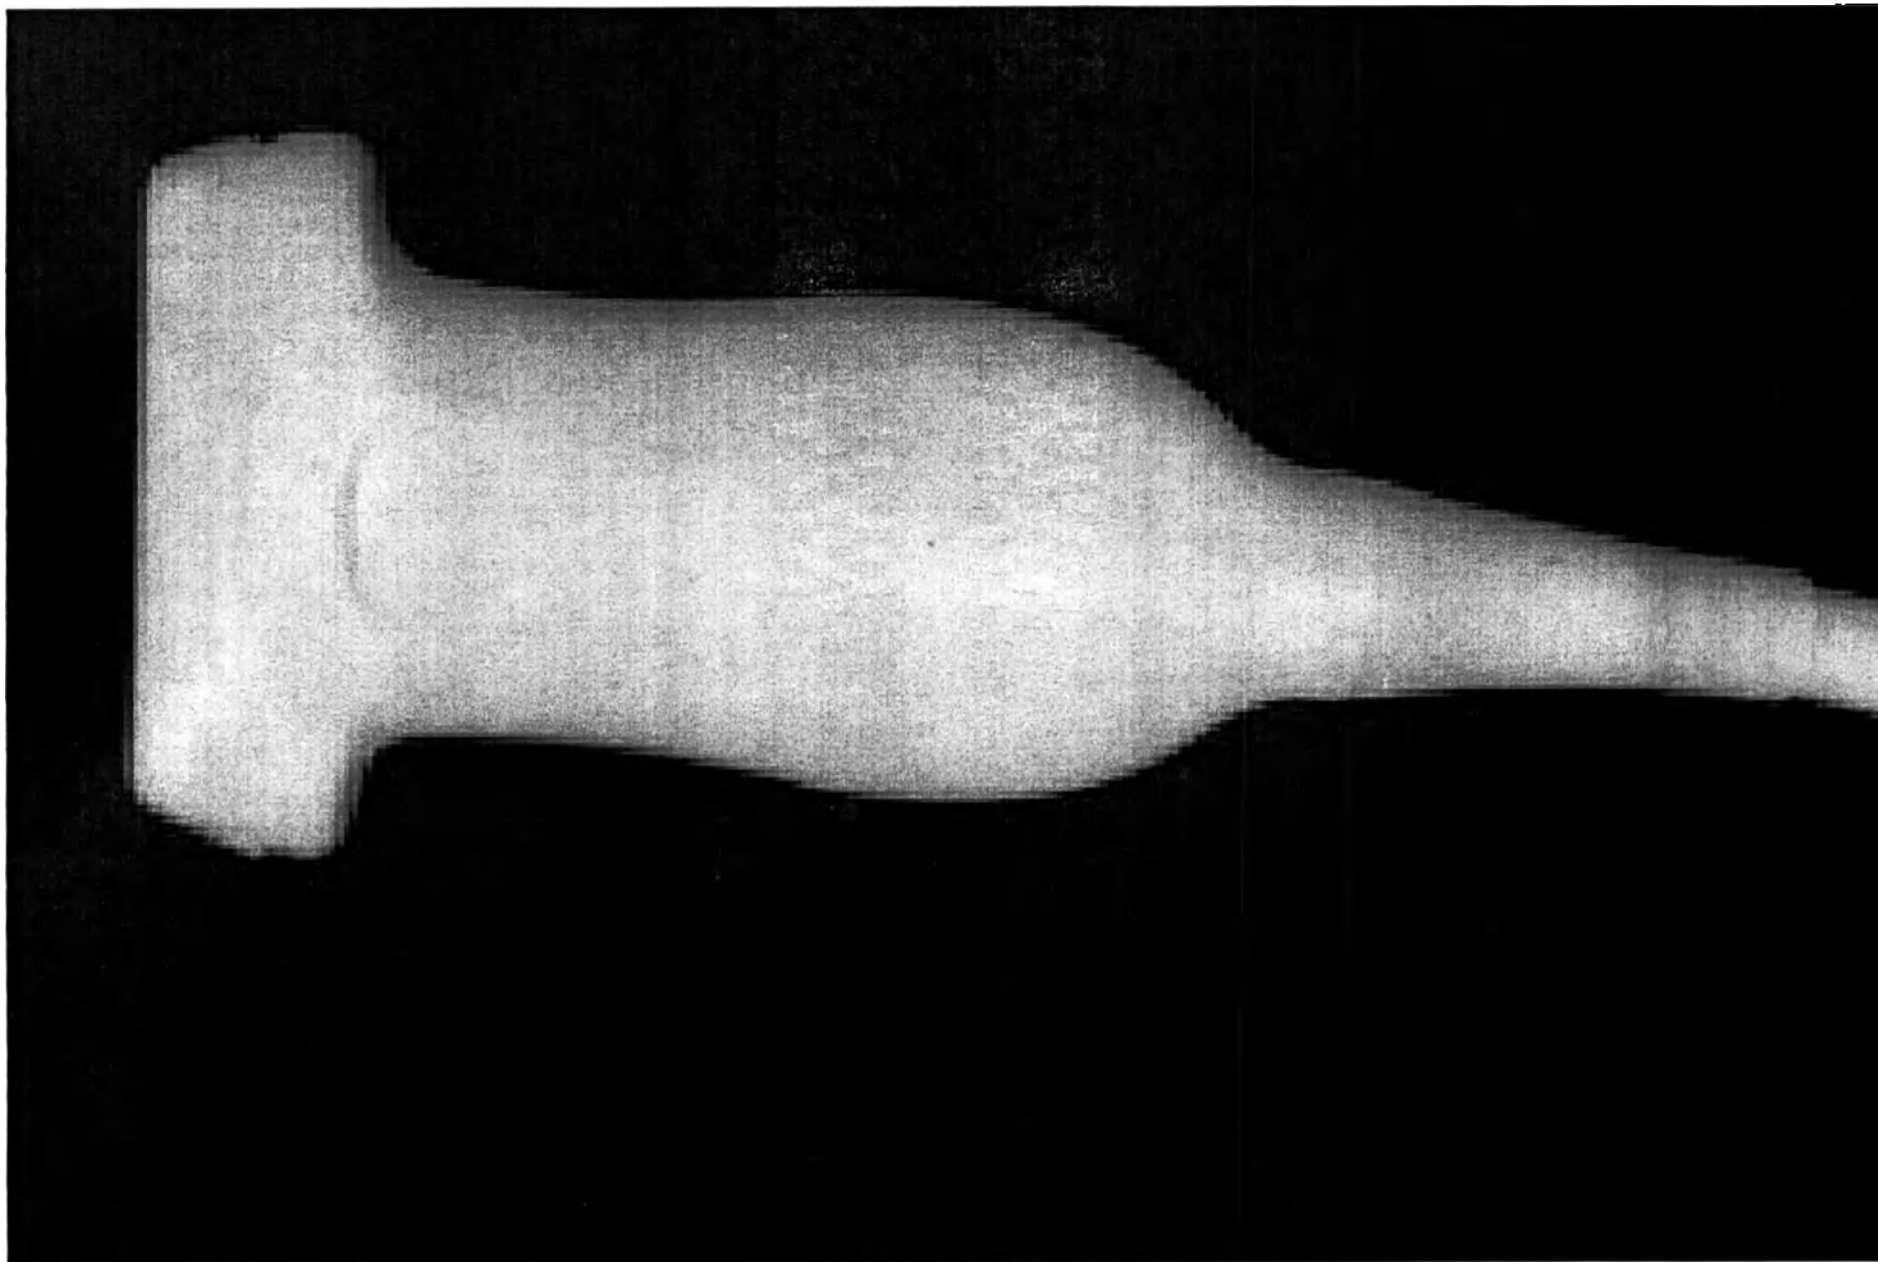


Датчик линейный LA3-14AD

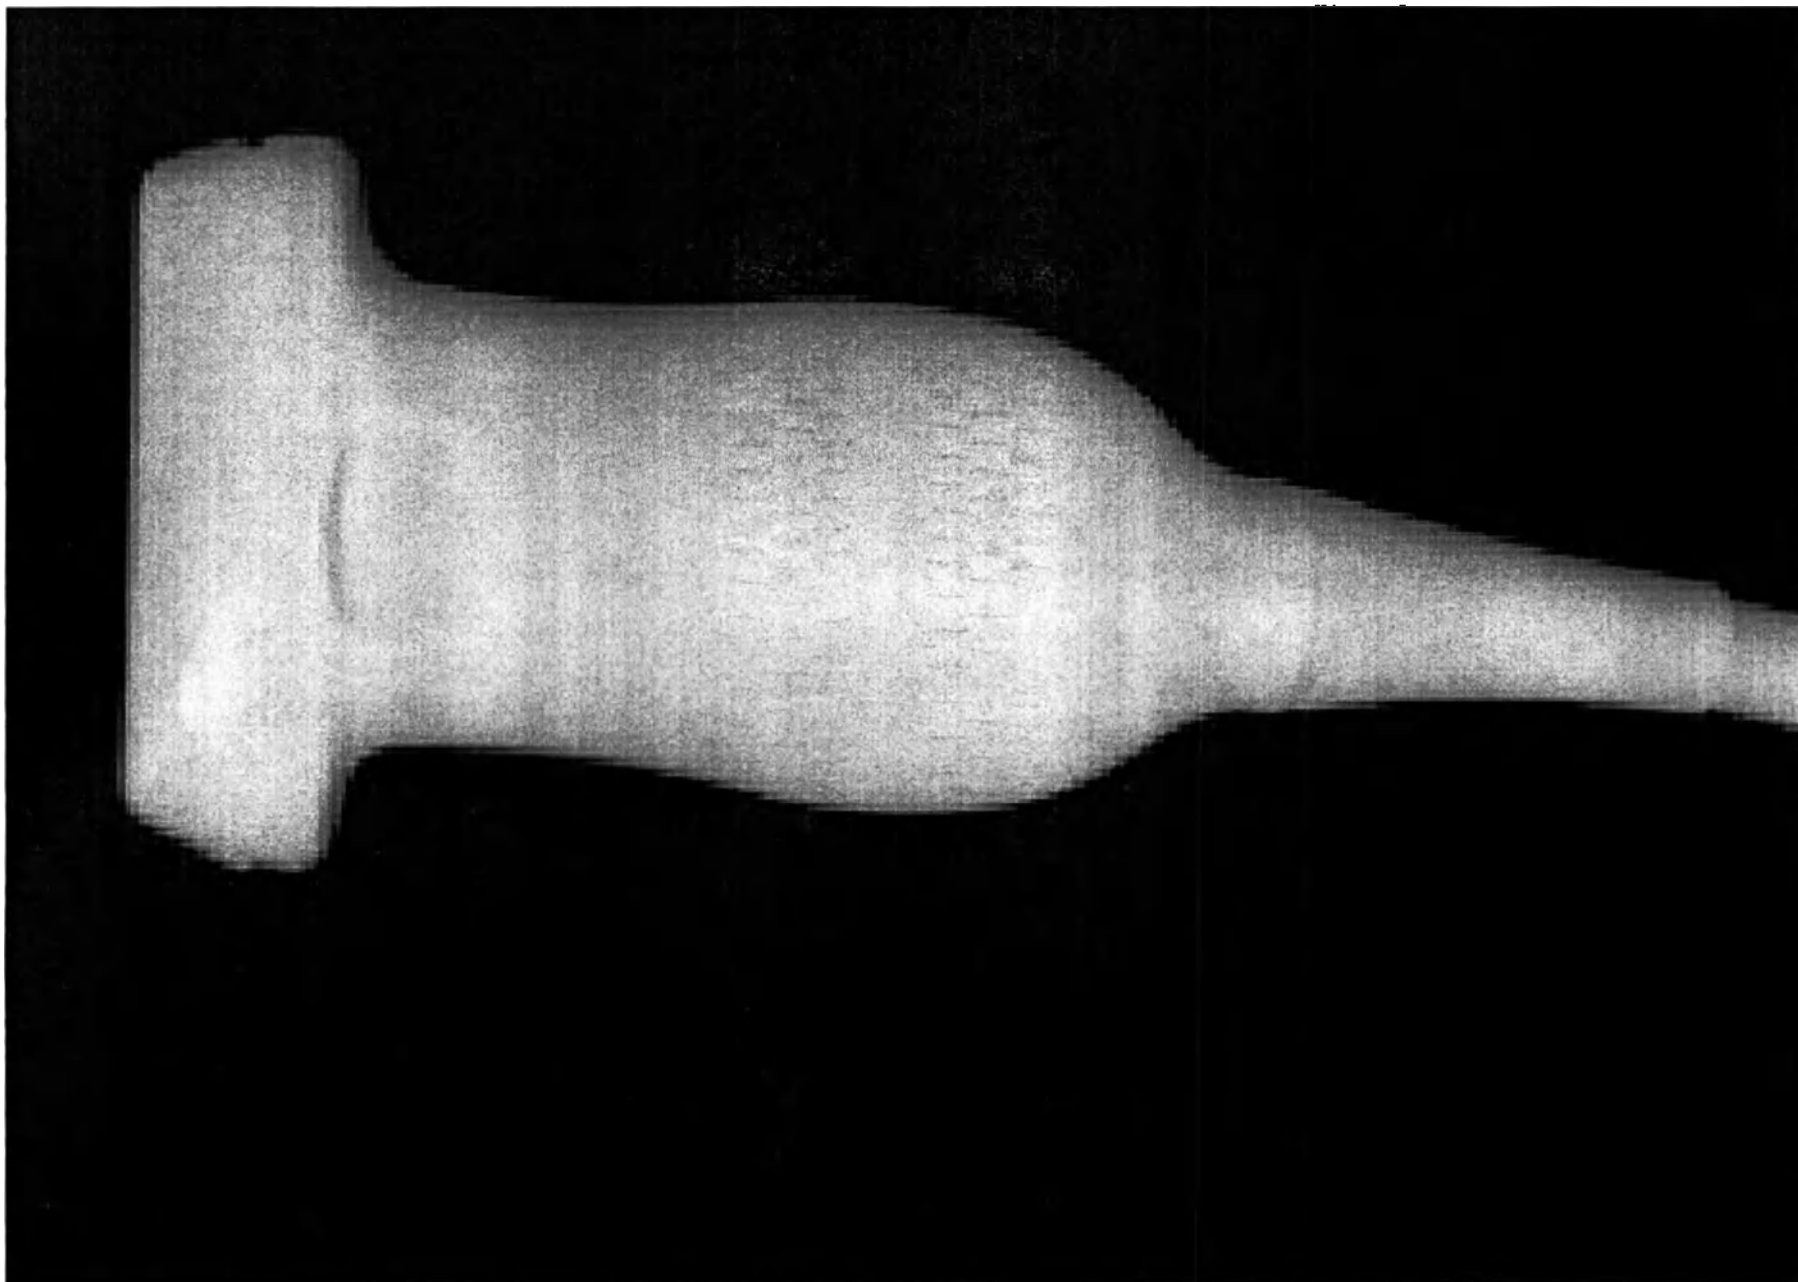


Датчик линейный LA3-19B

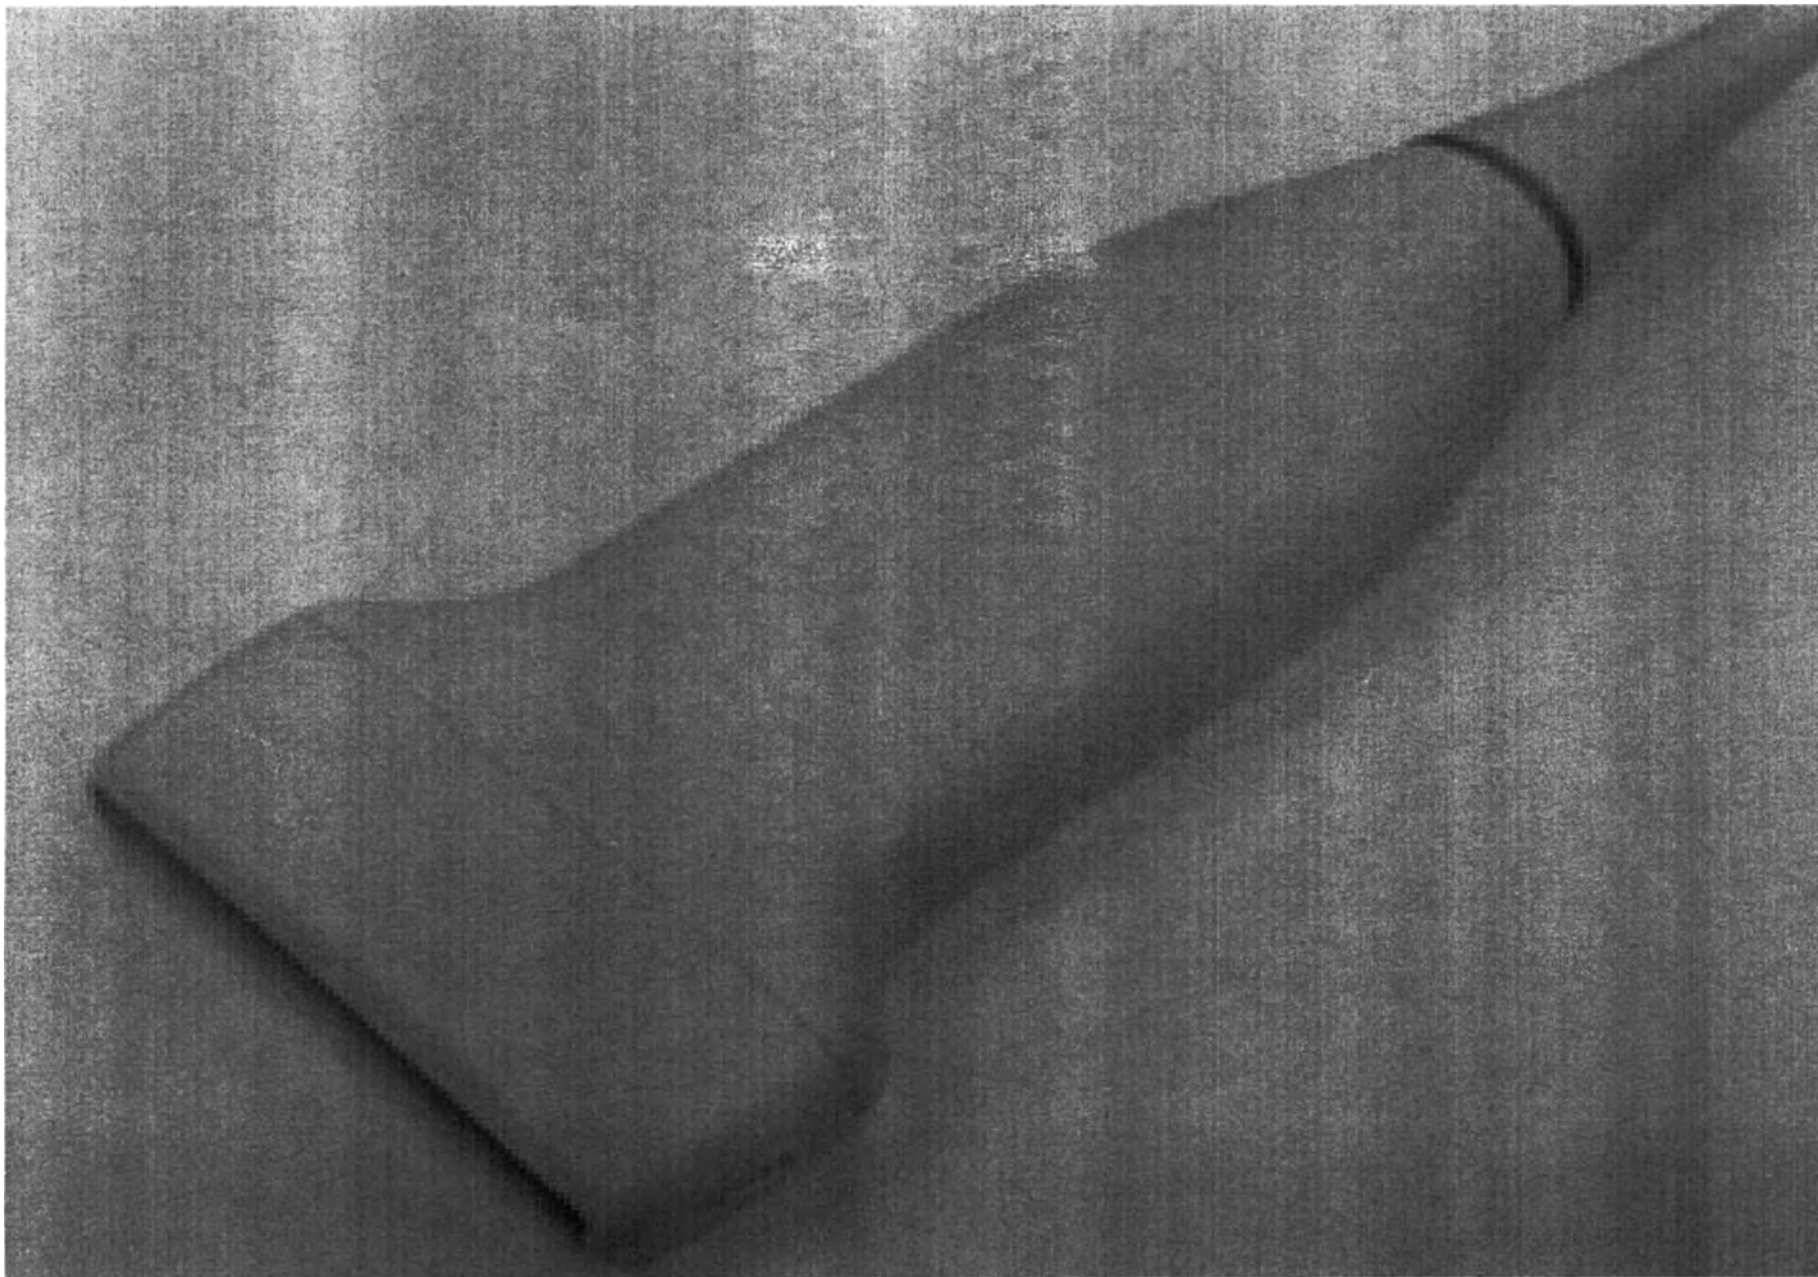


Датчик линейный LA3-16AD

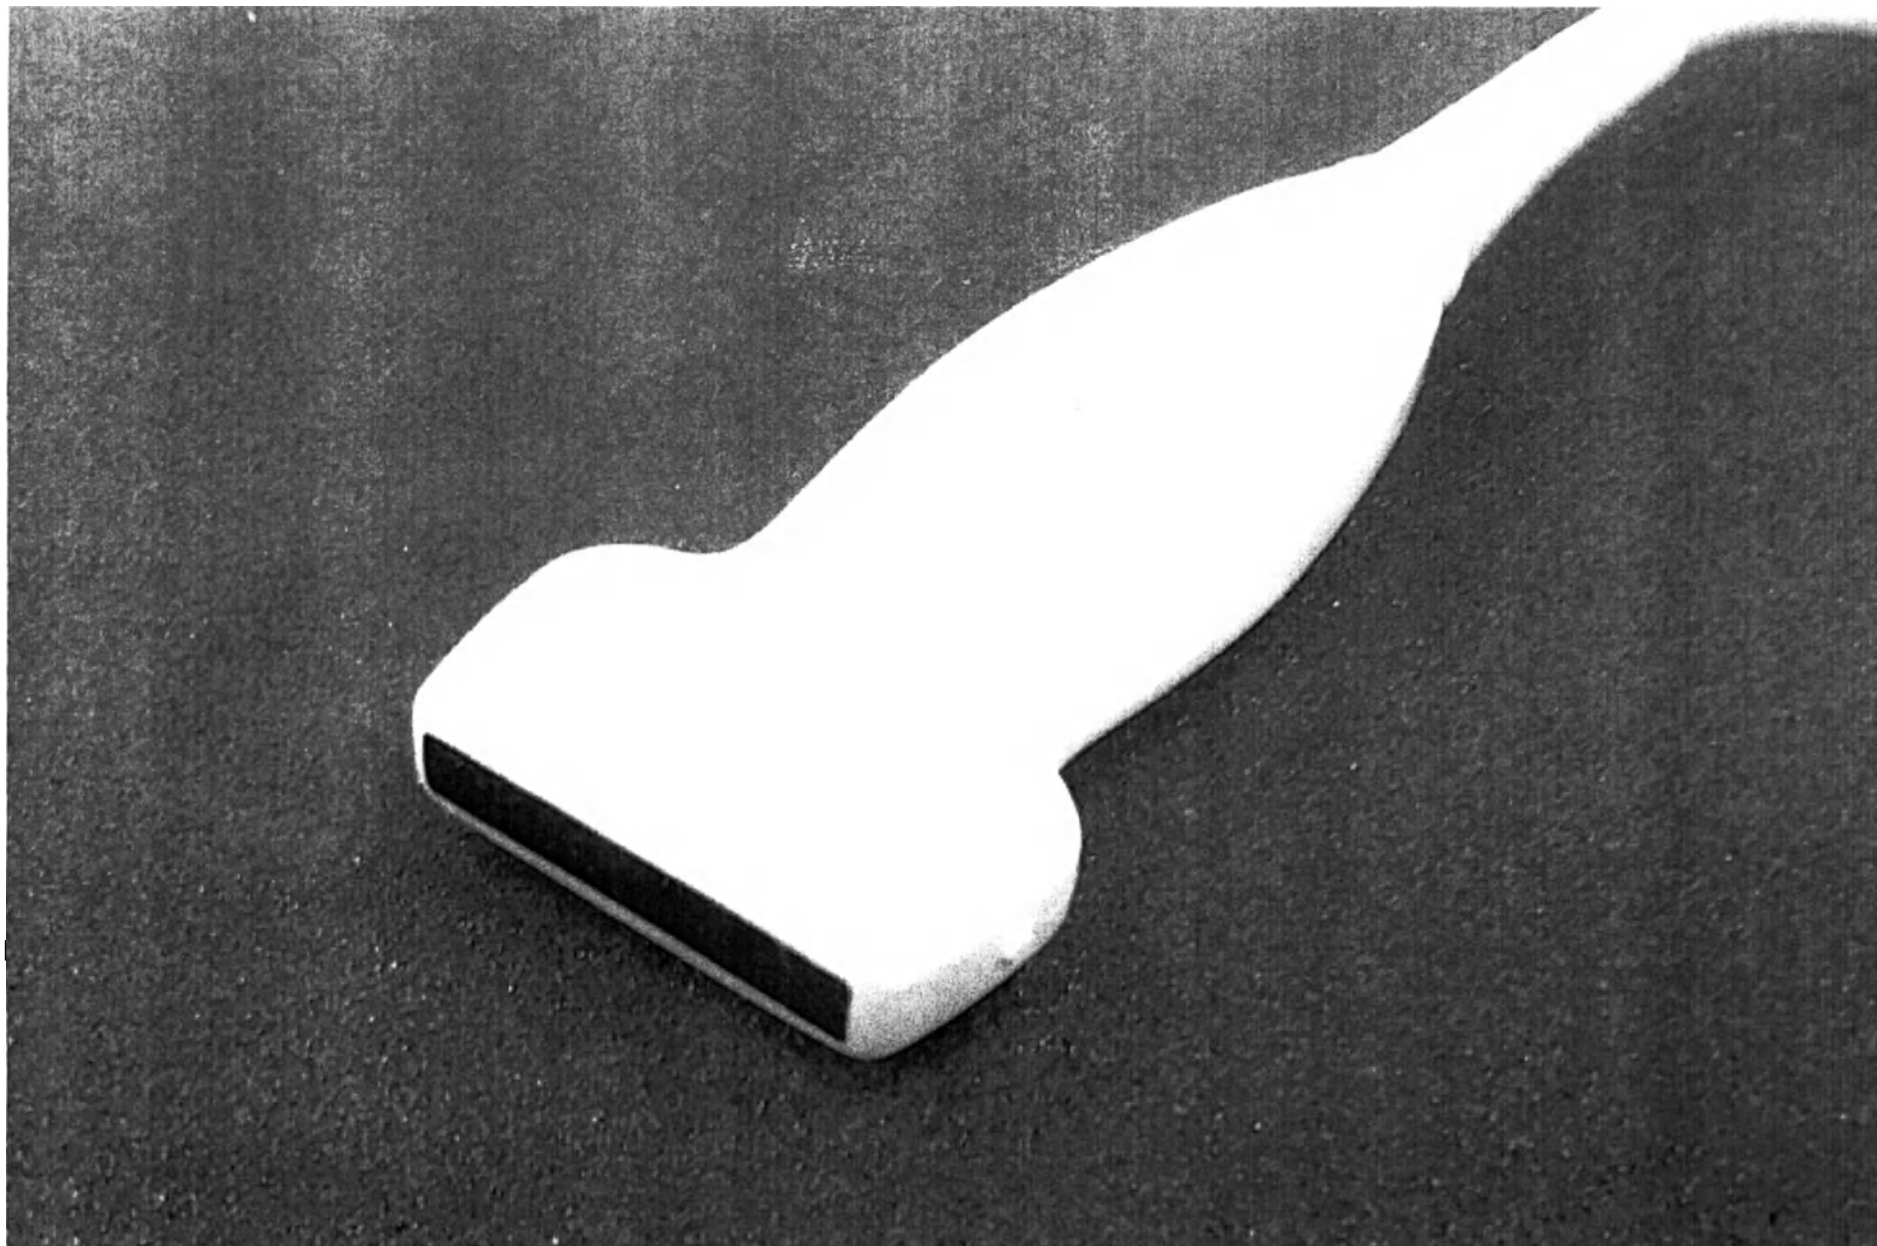


Датчик линейный LS3-14B (№ РЗН 2019/8227 от 22.03.2019)

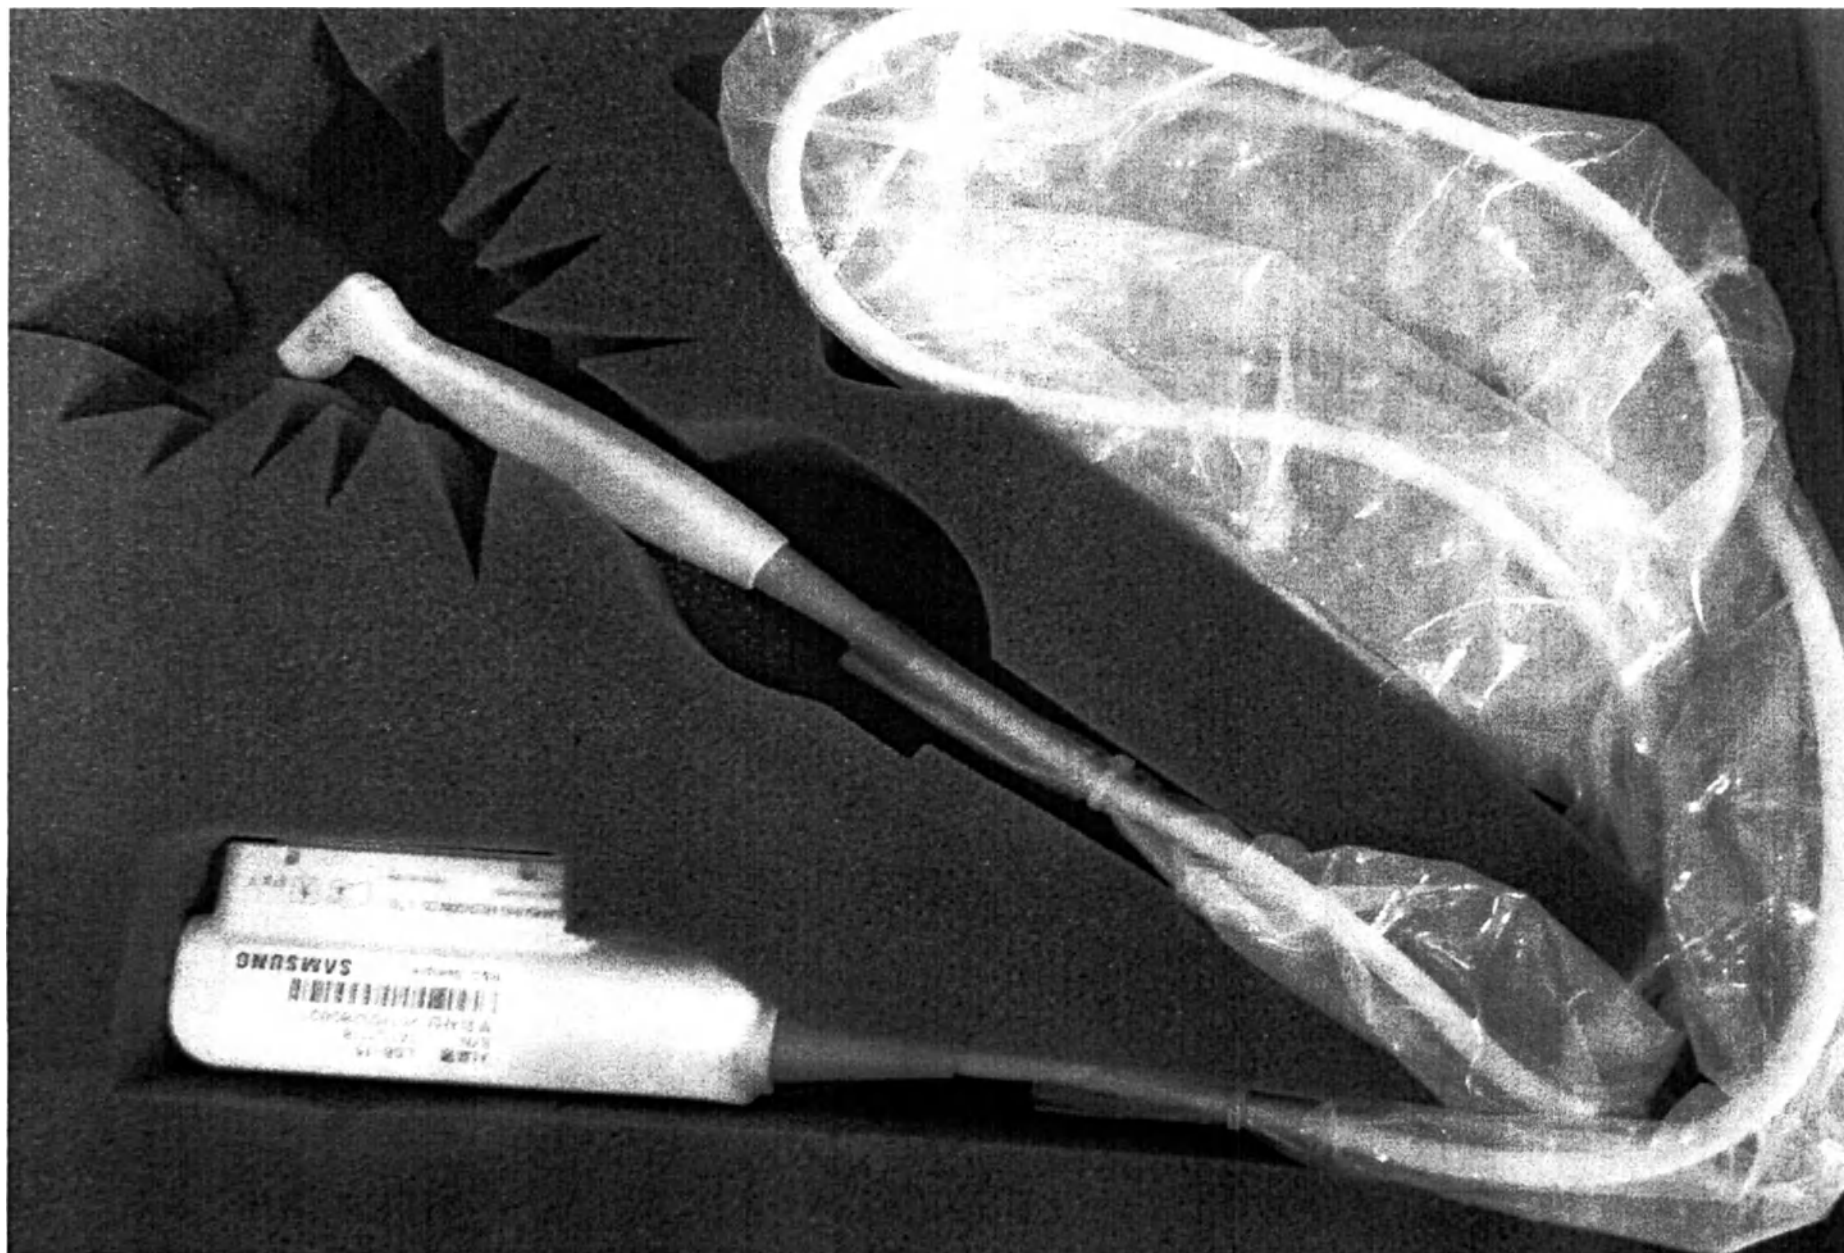


Датчик линейный LS6-15 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017)

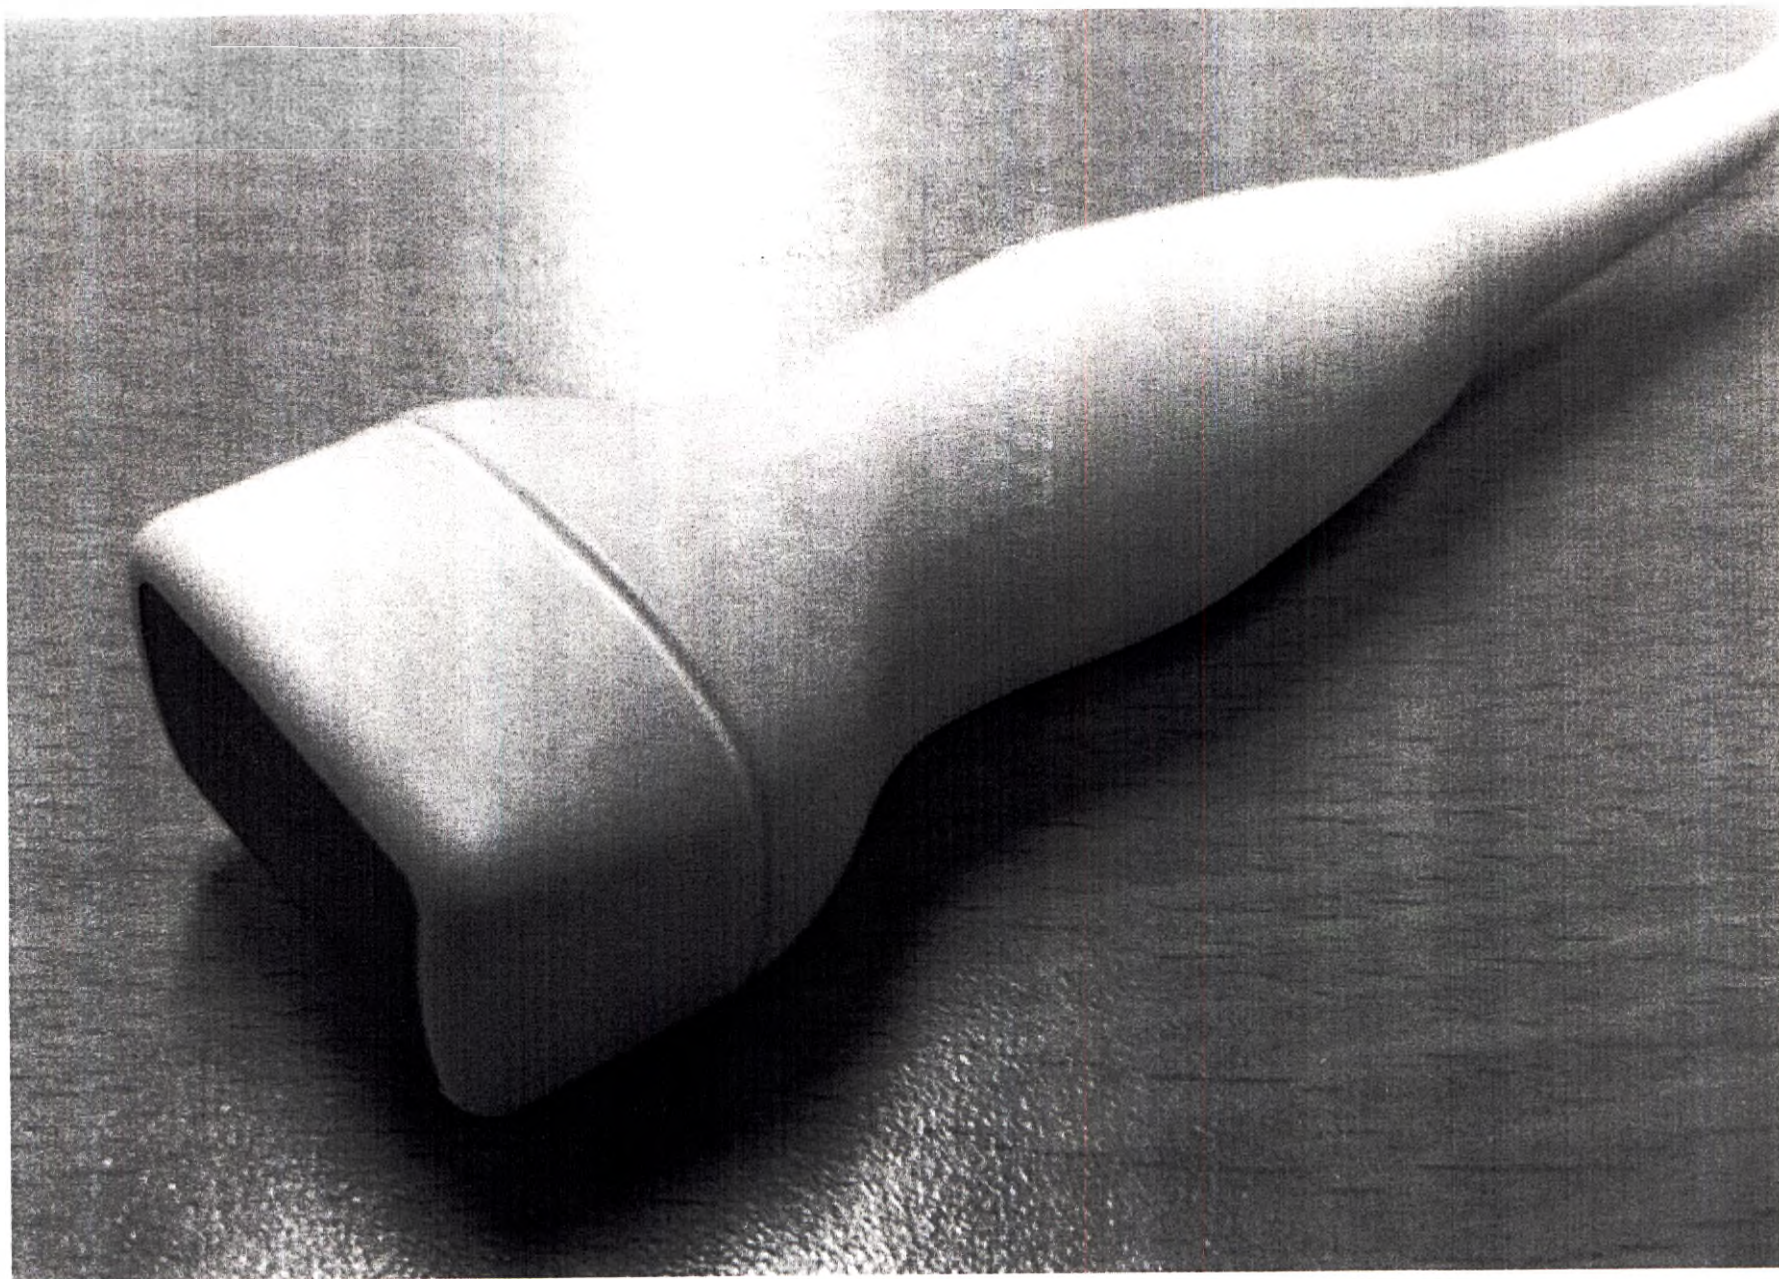


Датчик фазированный РЕ2-4

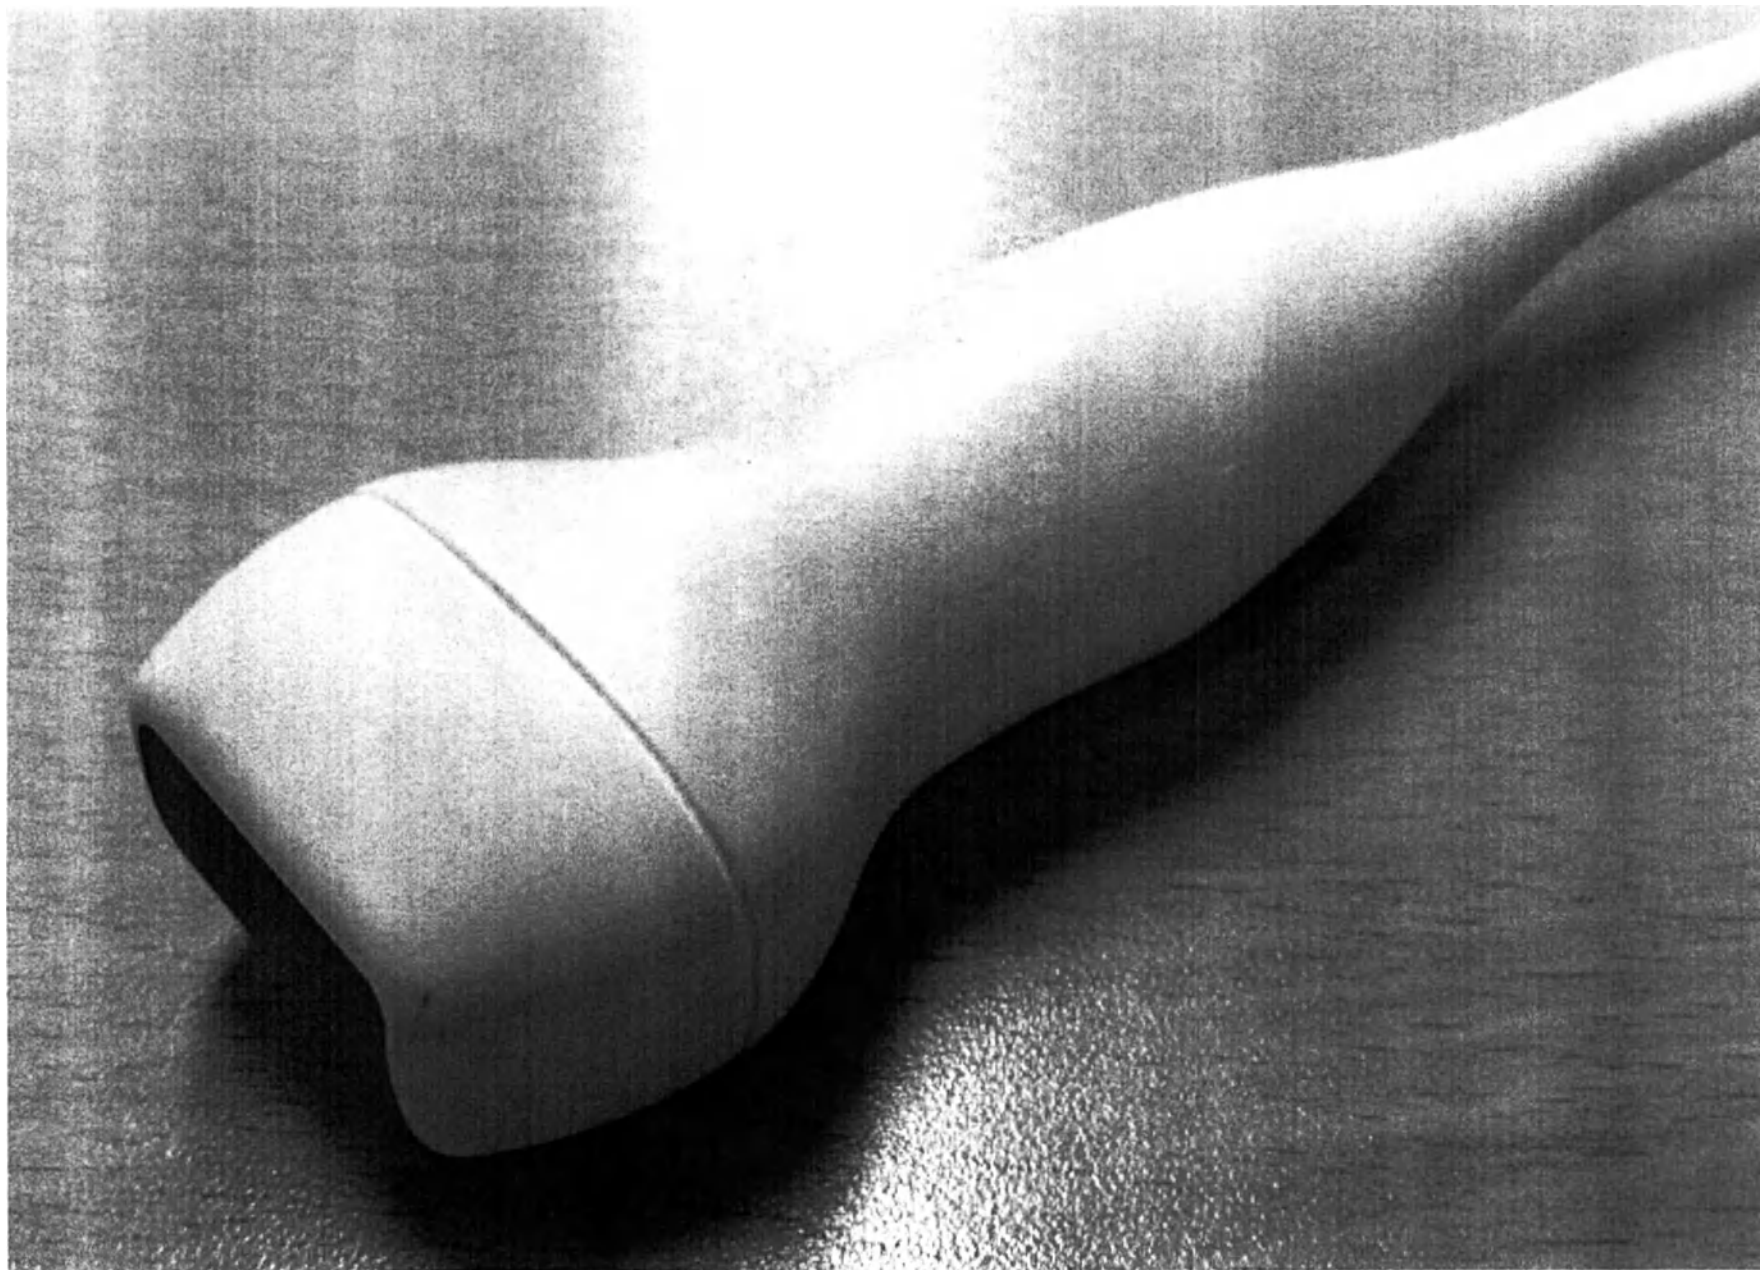


Датчик фазированный РЗ-8

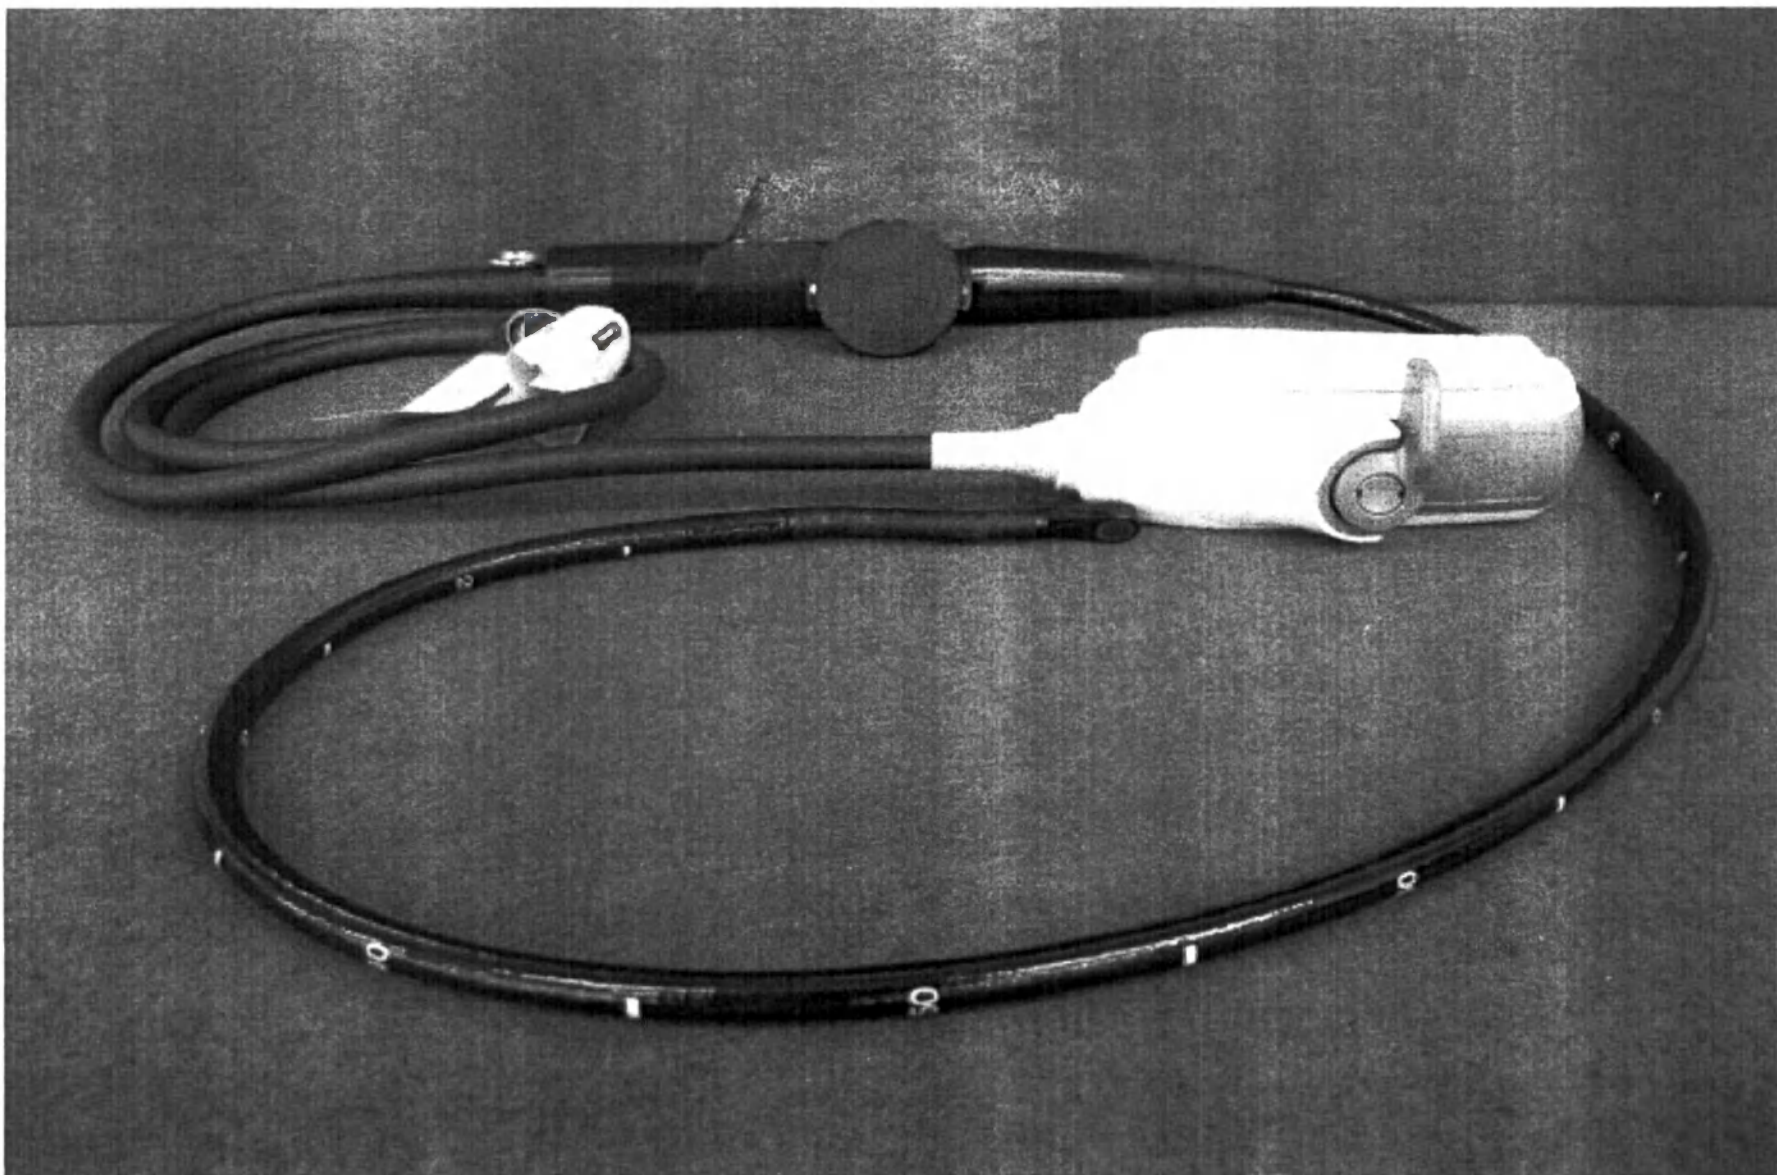


Датчик фазированный ММРТ3-7

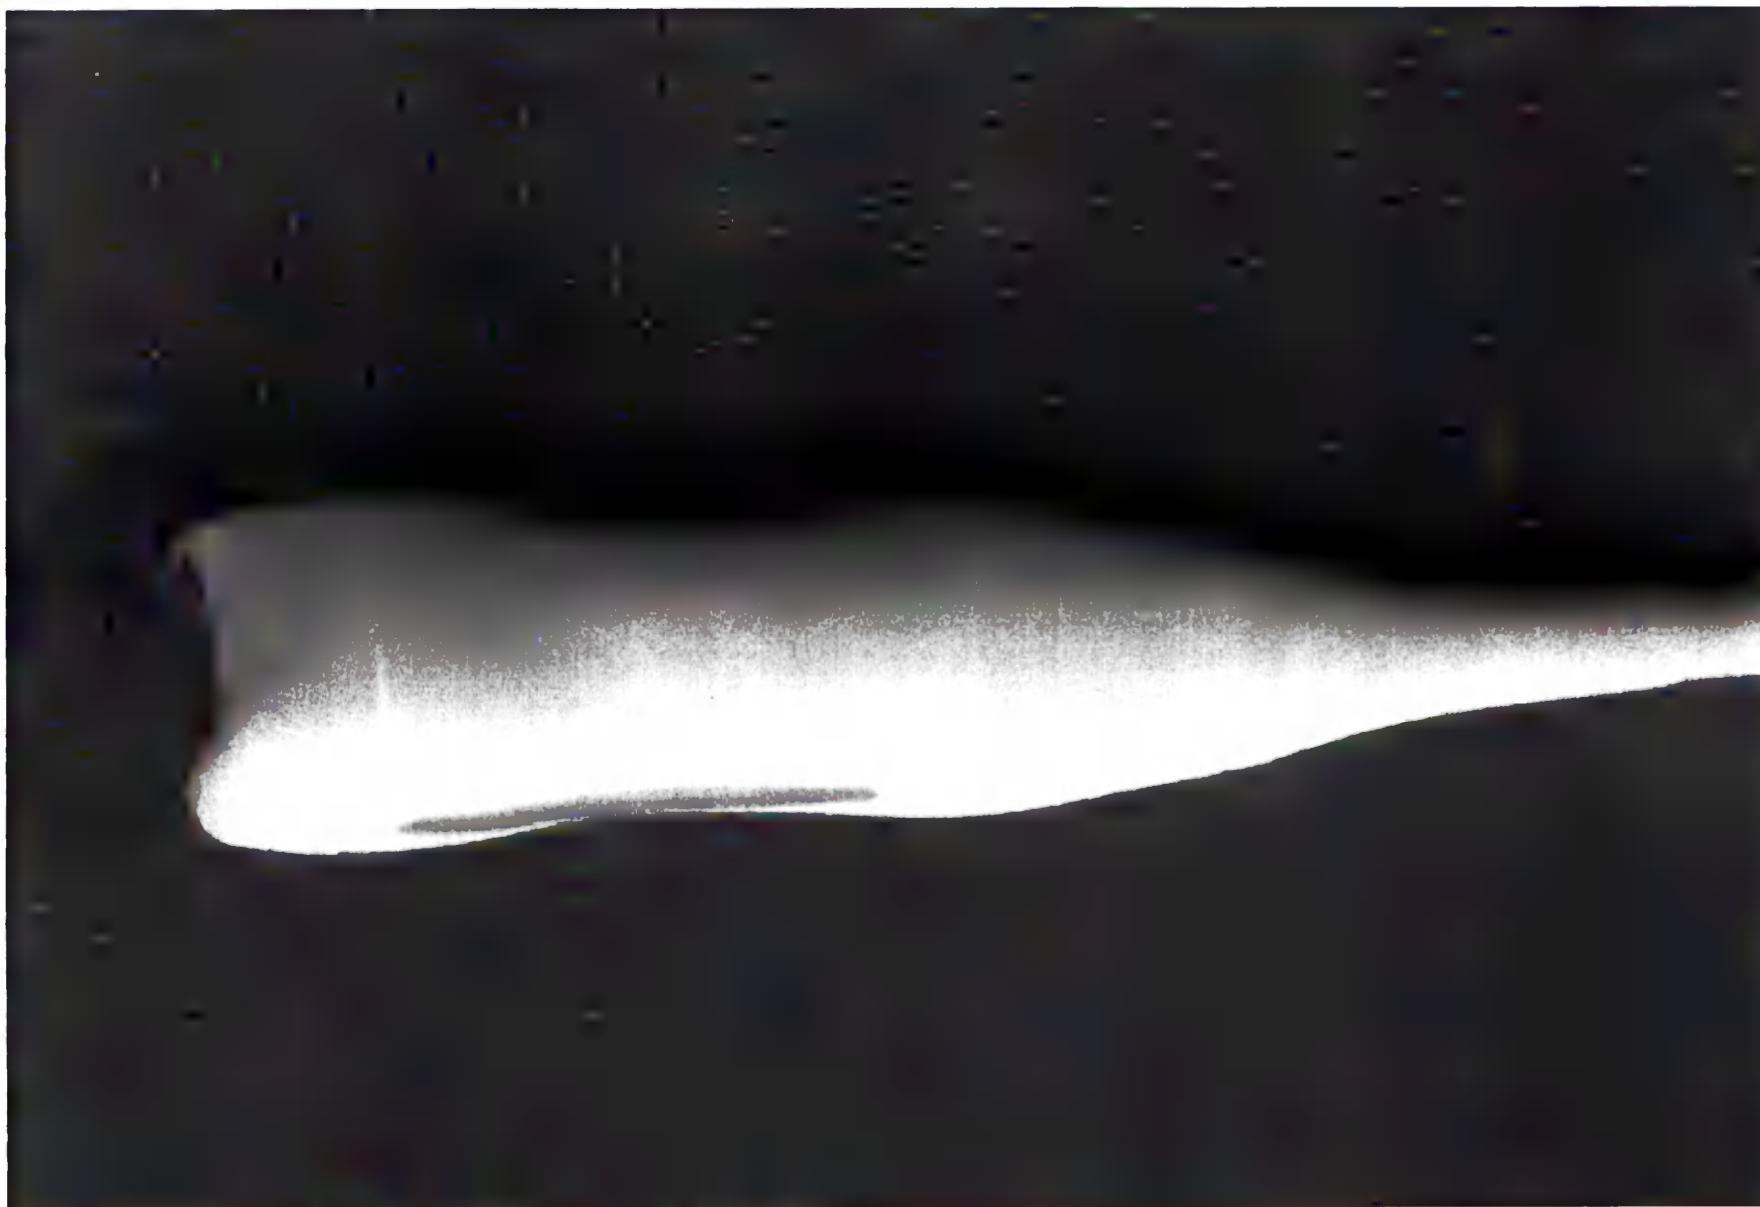


Датчик фазированный Р4-12 (№ РЗН 2015/3259 от 28.10.2015)

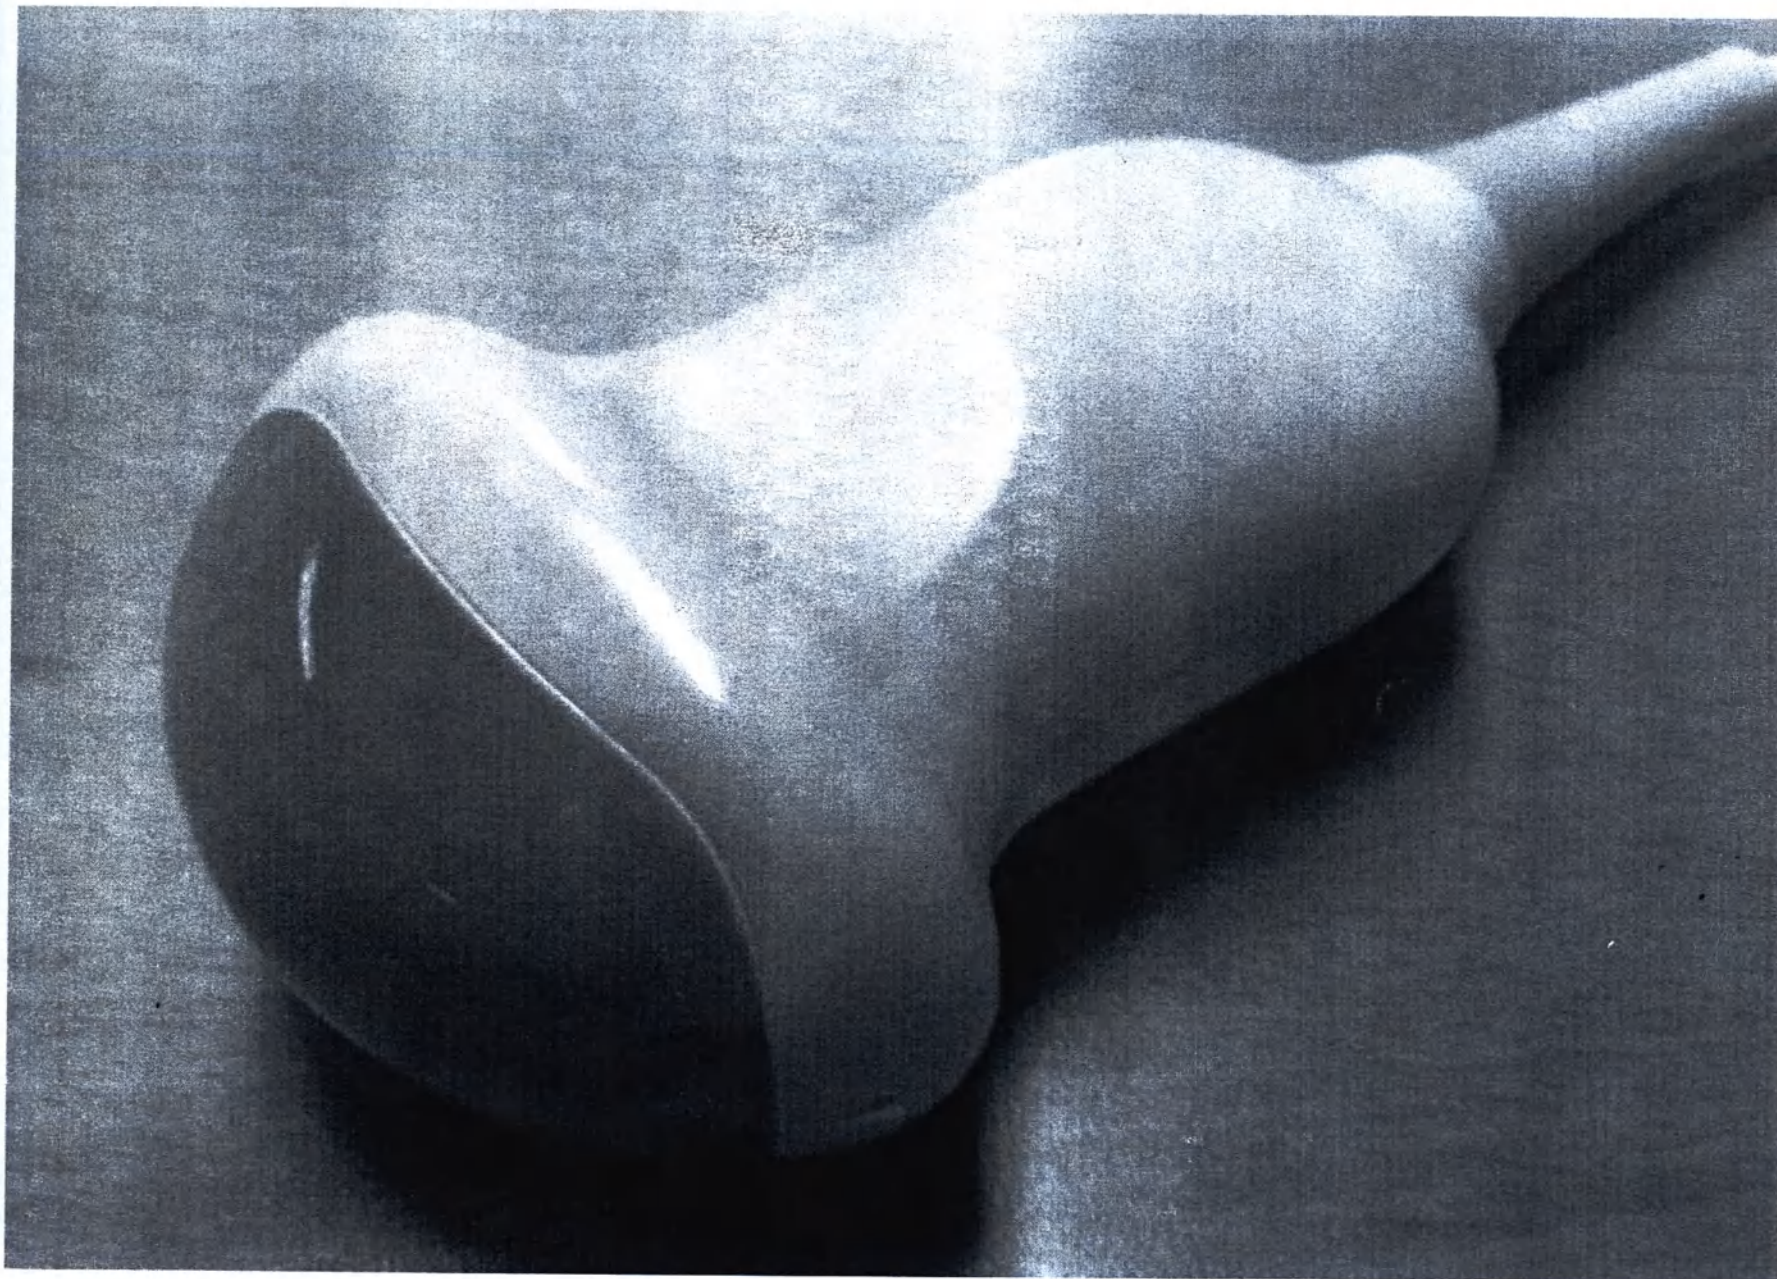

Датчик объемный VN4-8

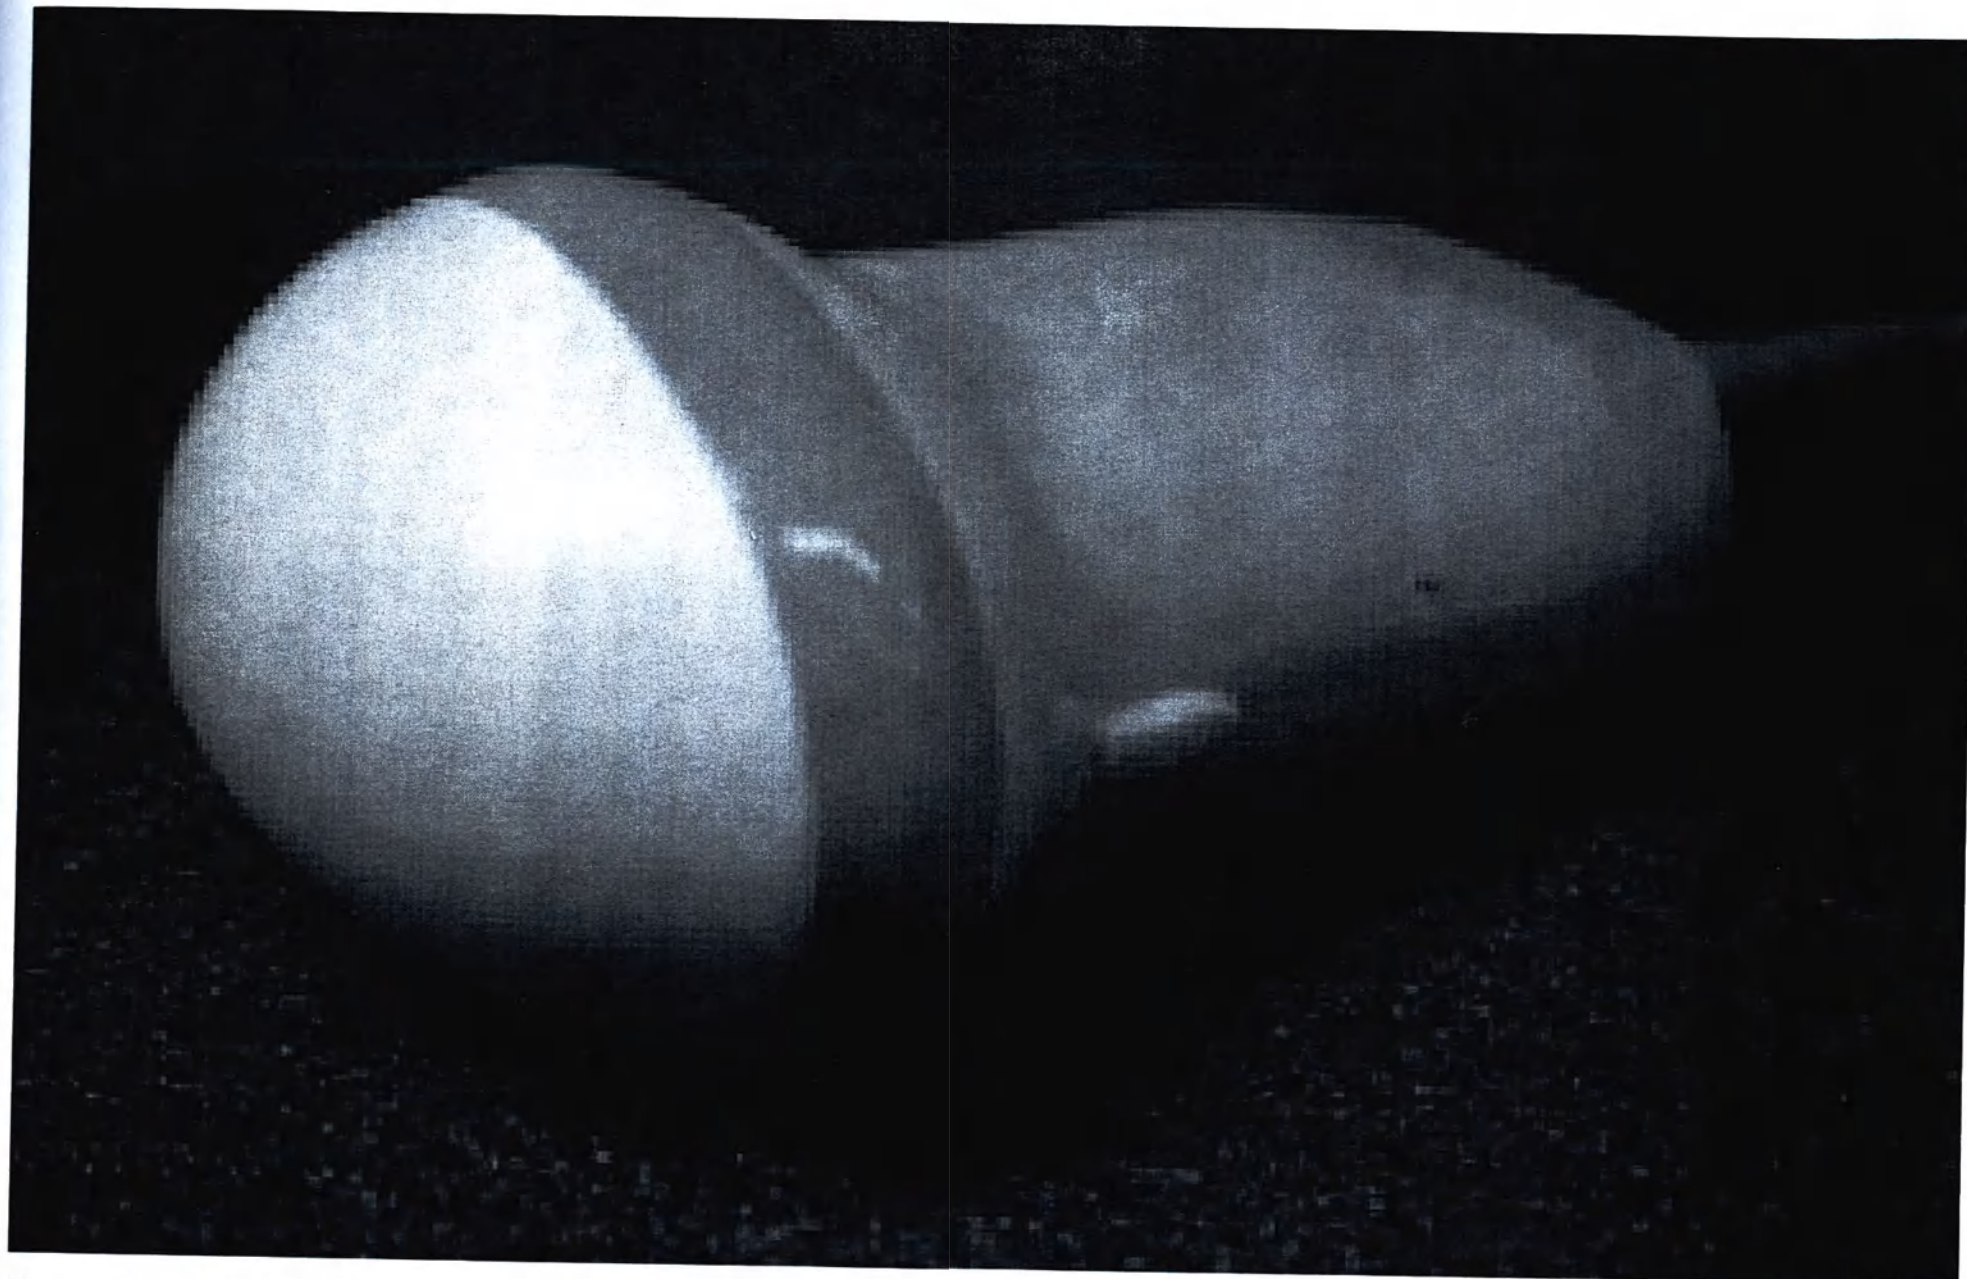


Датчик объемный 3D4-8

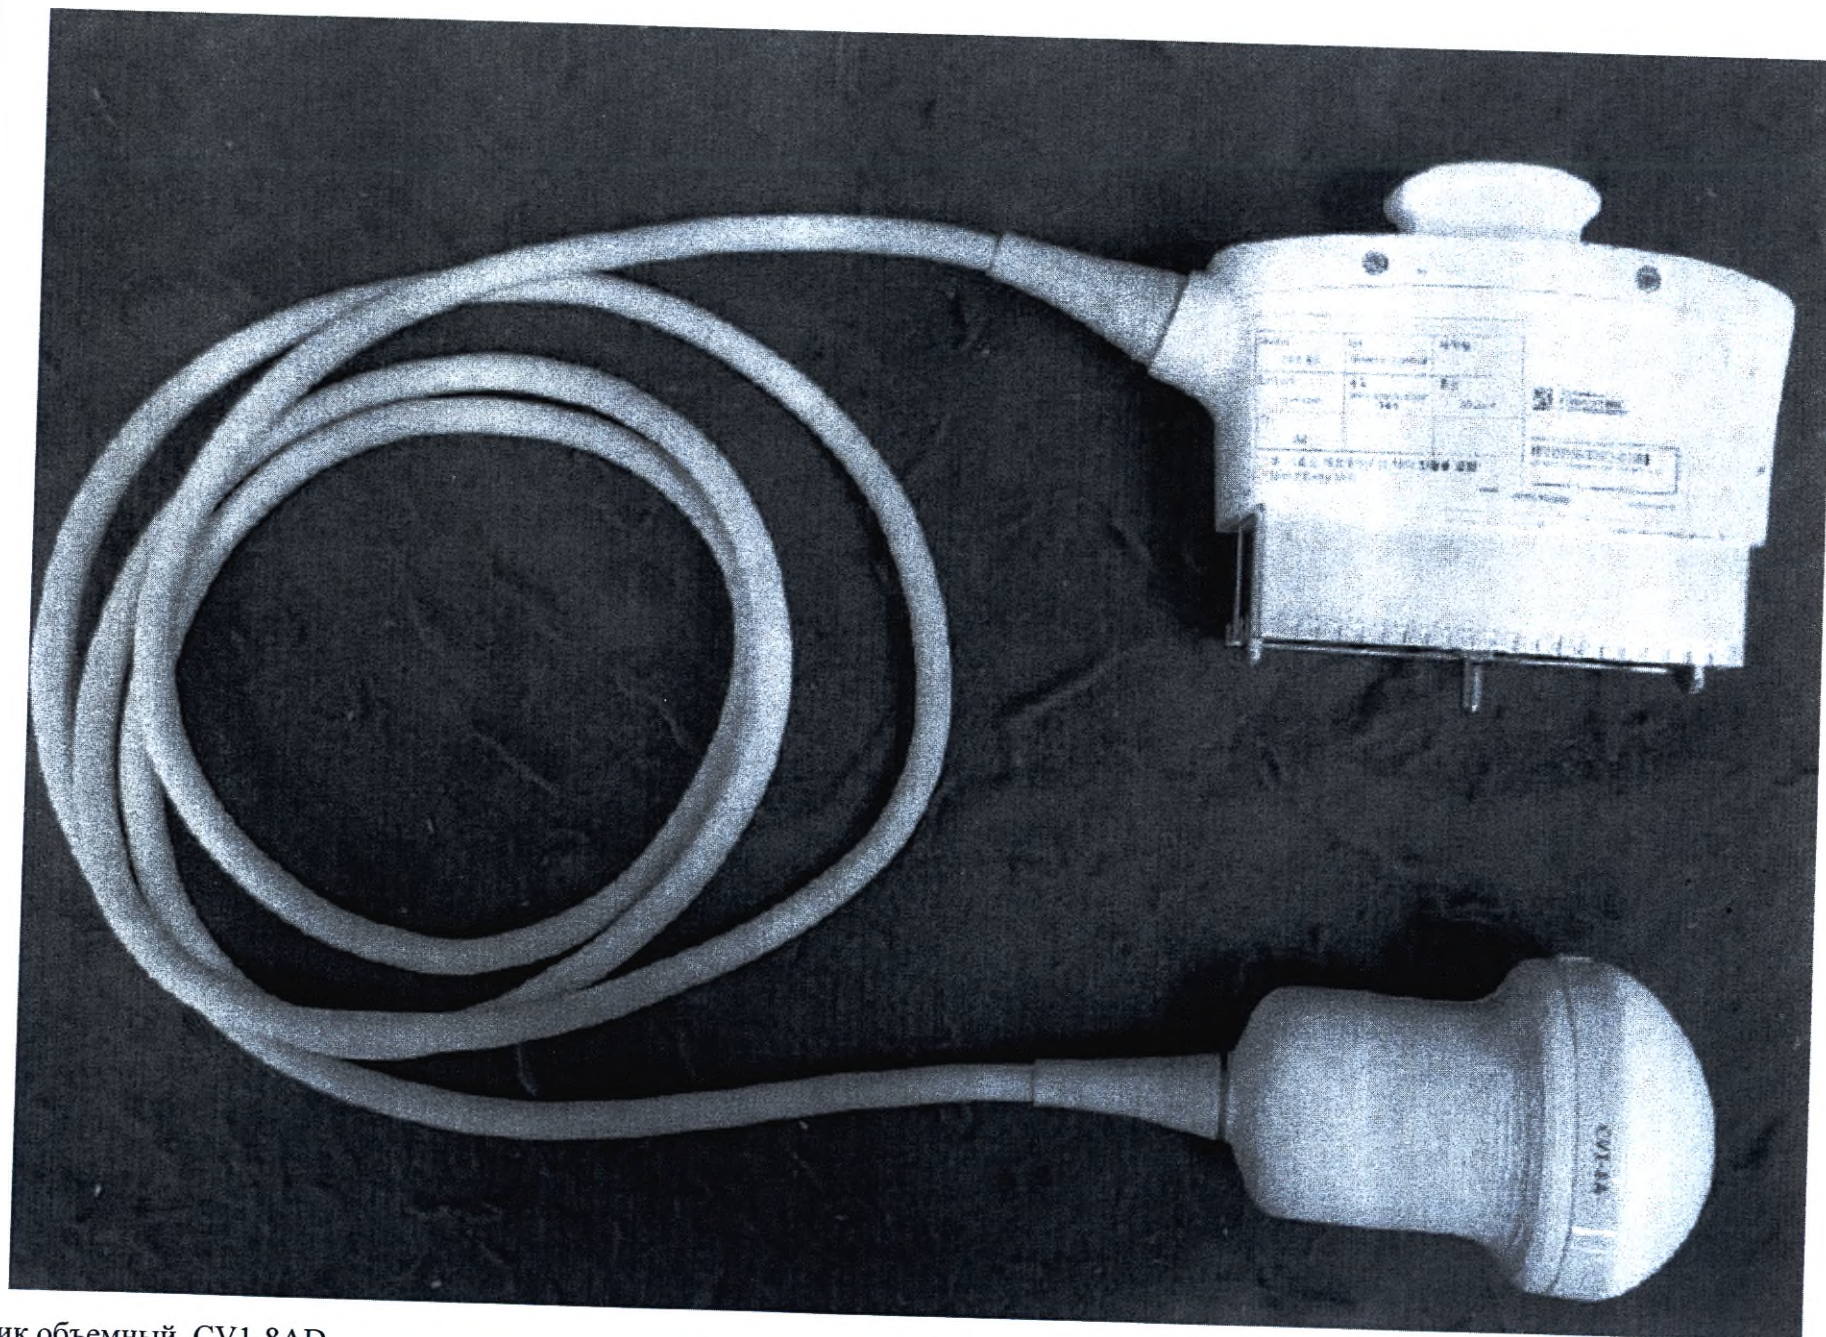


Датчик объемный CV1-8AD




Датчик объемный V5-9

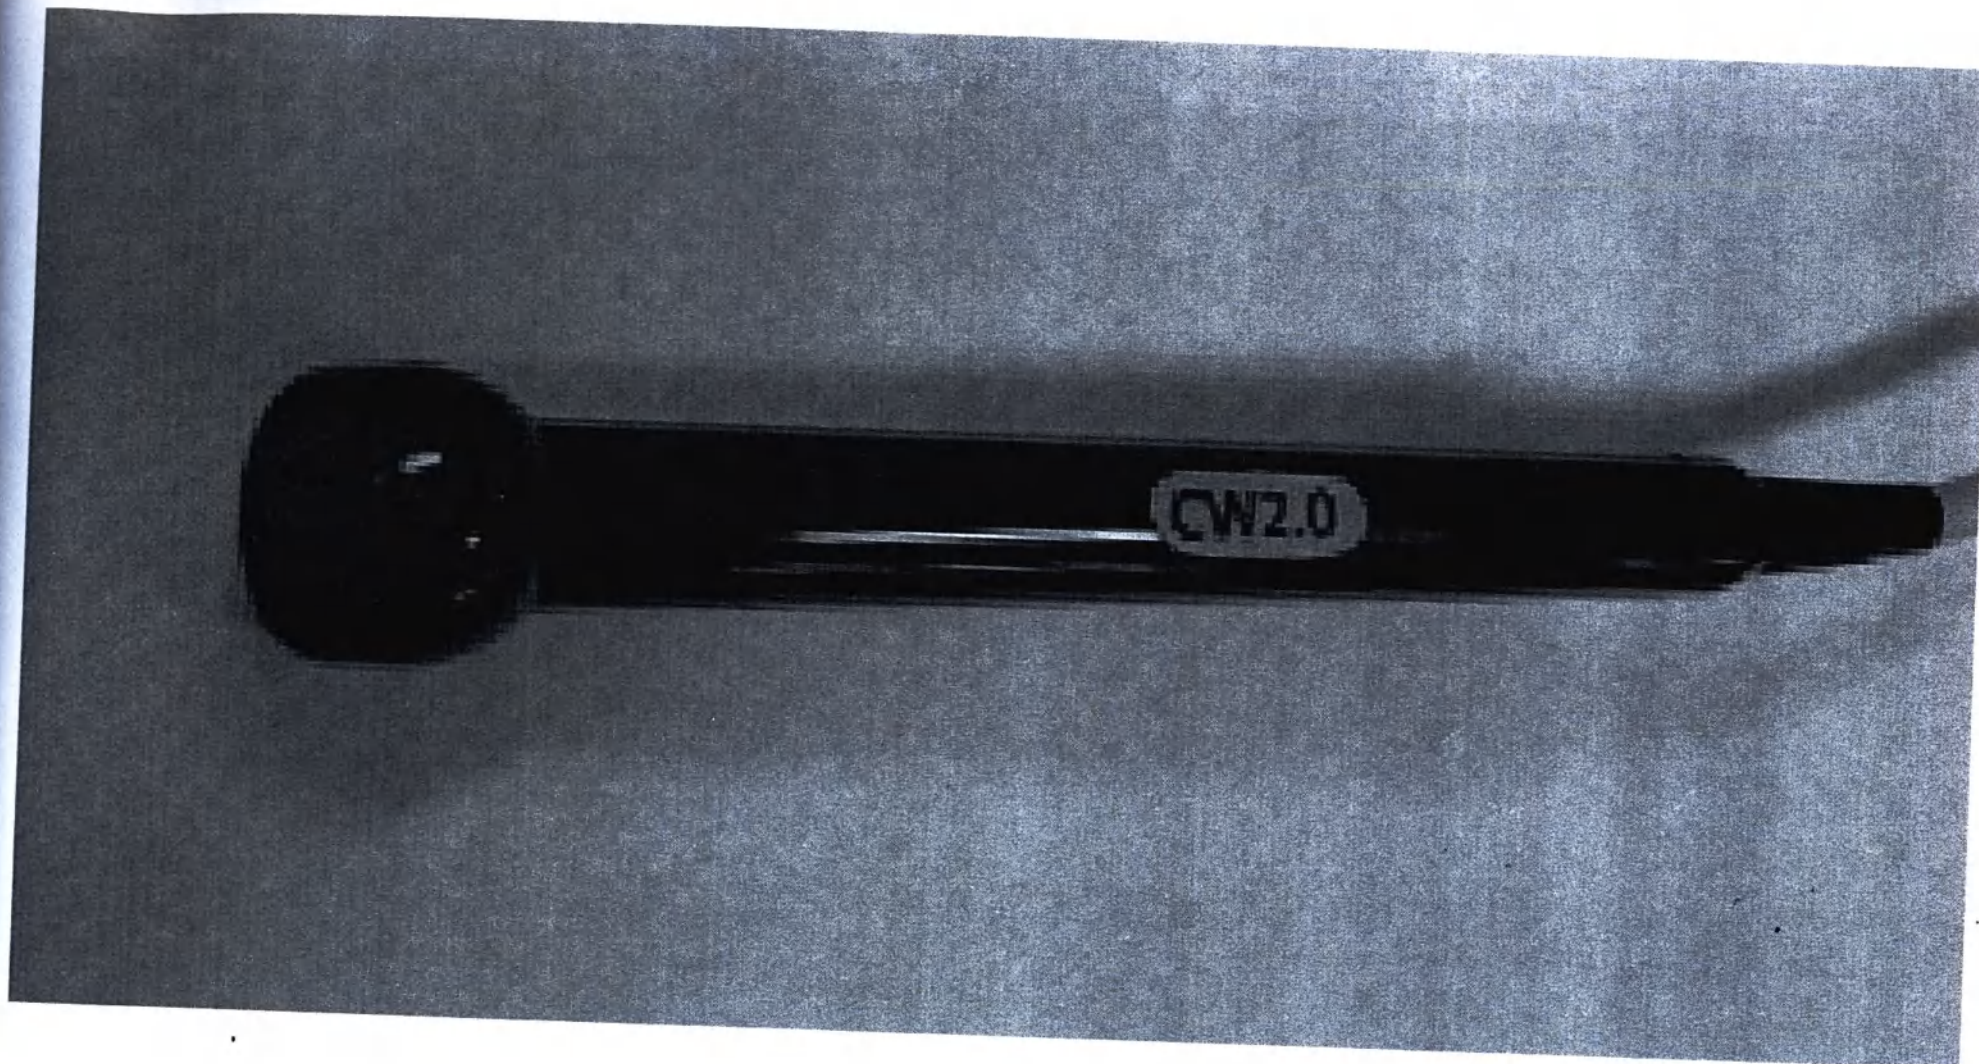


Датчик постоянно-волновой CW 2.0

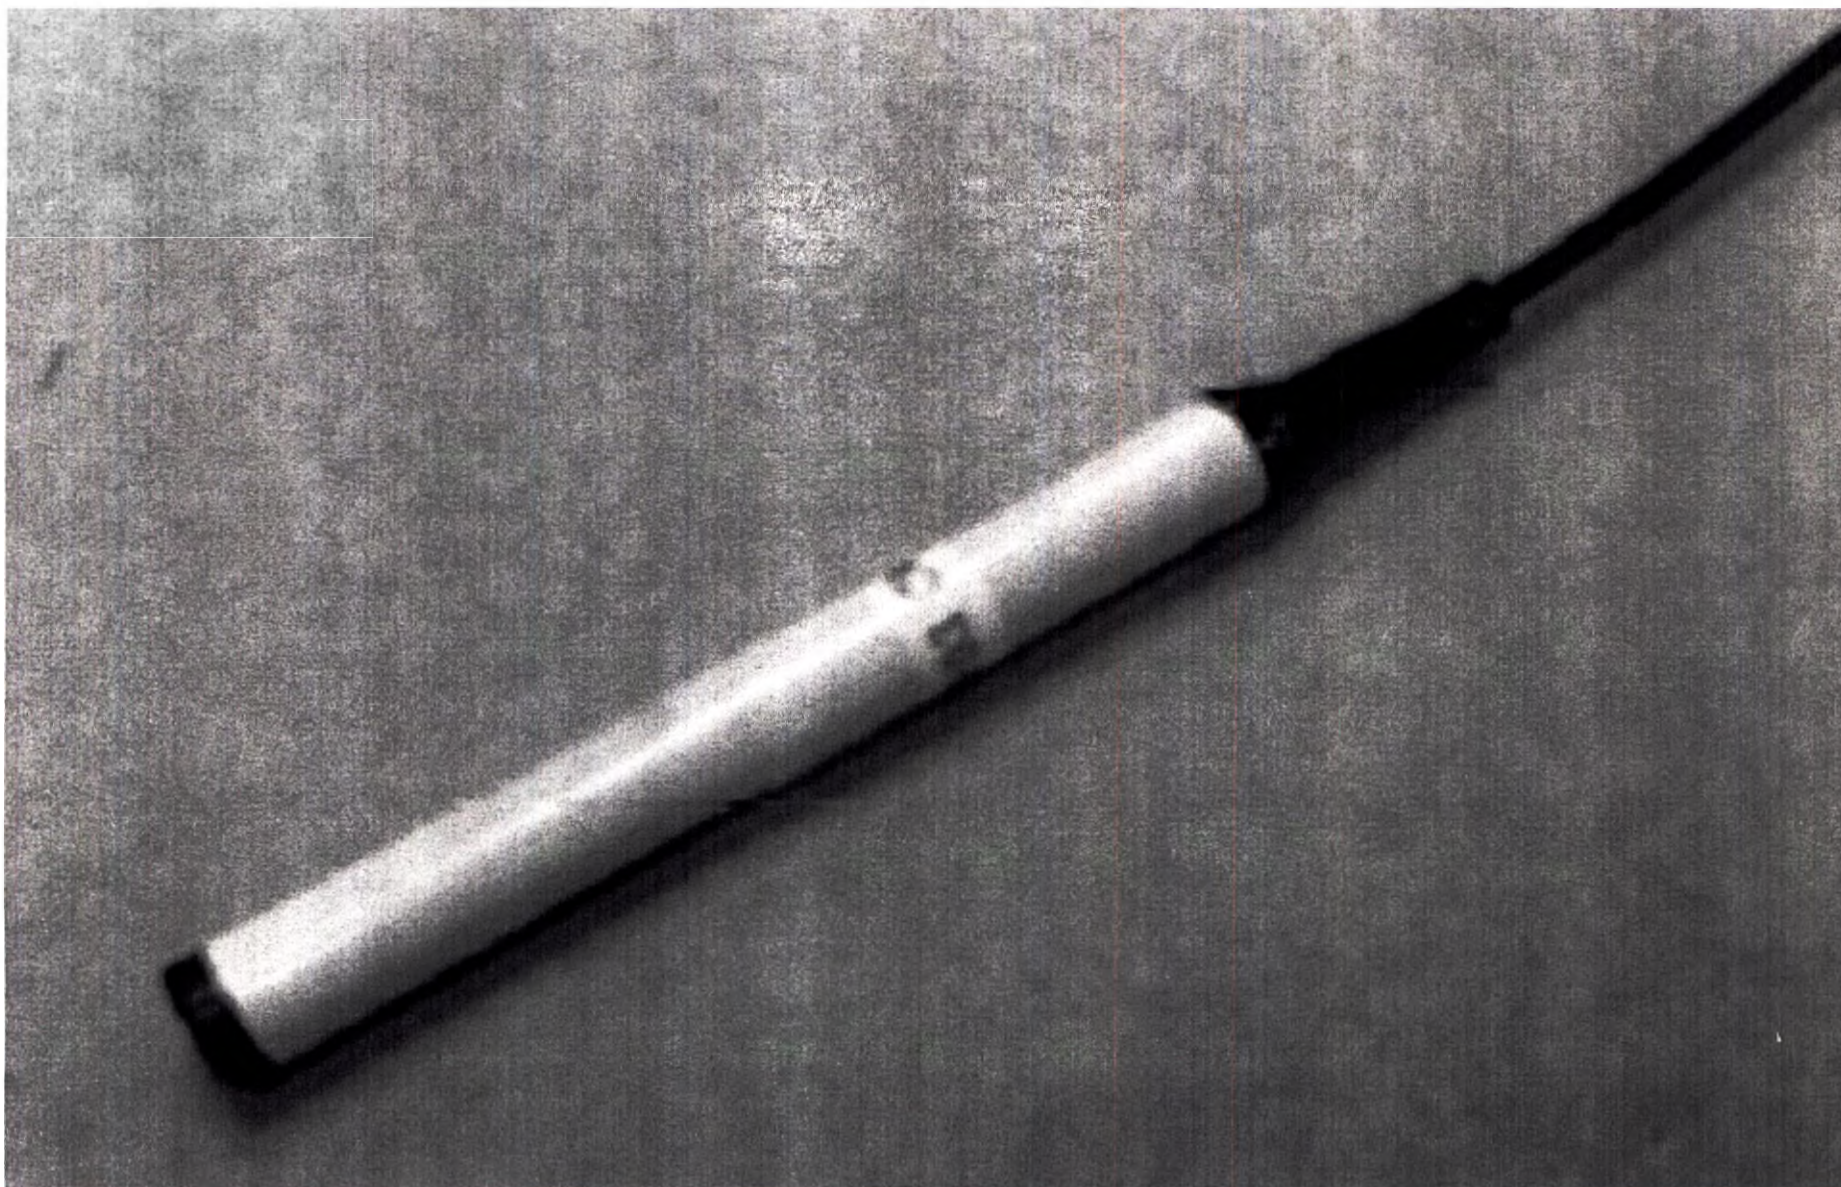


Датчик постоянно-волновой CW4.0

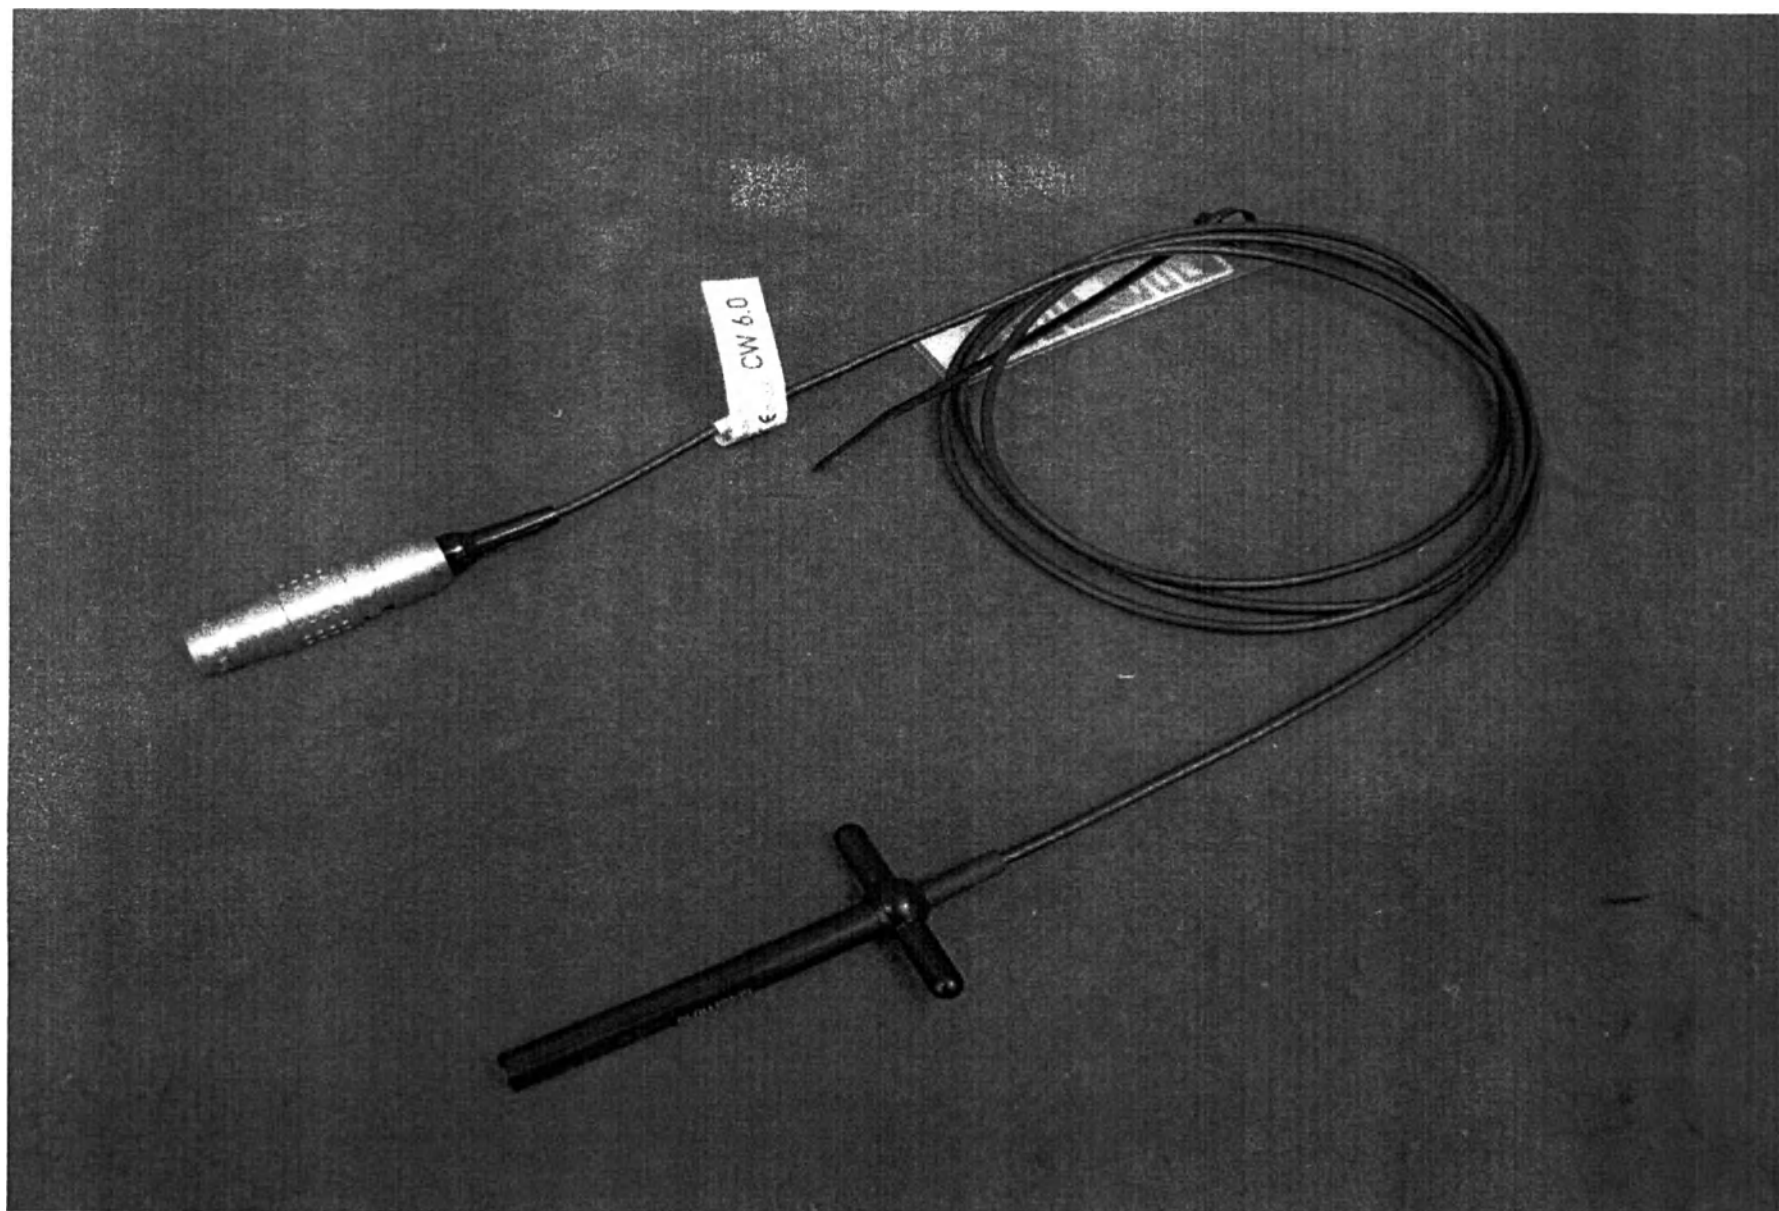


Датчик постоянно-волновой CW6.0

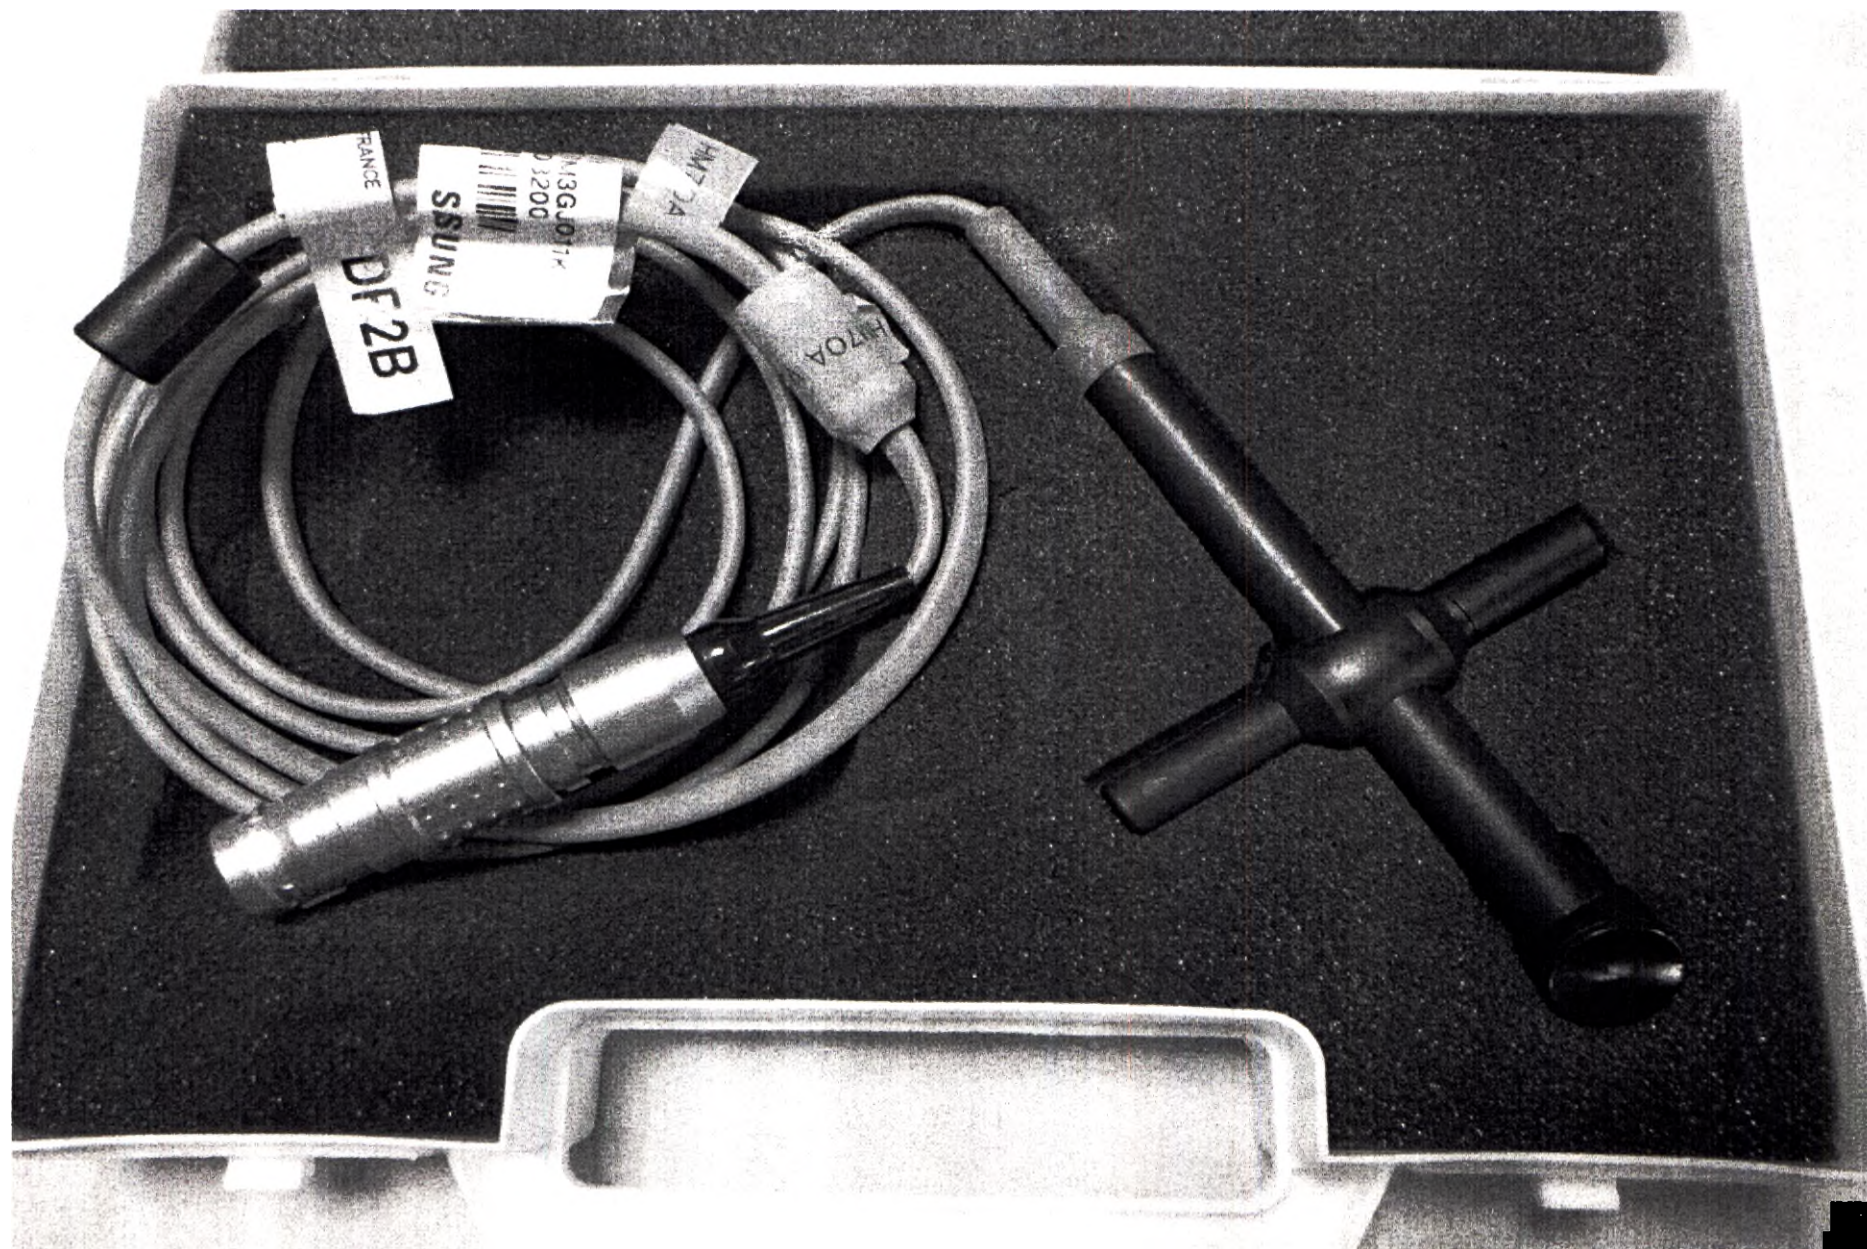


Датчик постоянно-волновой DP2B

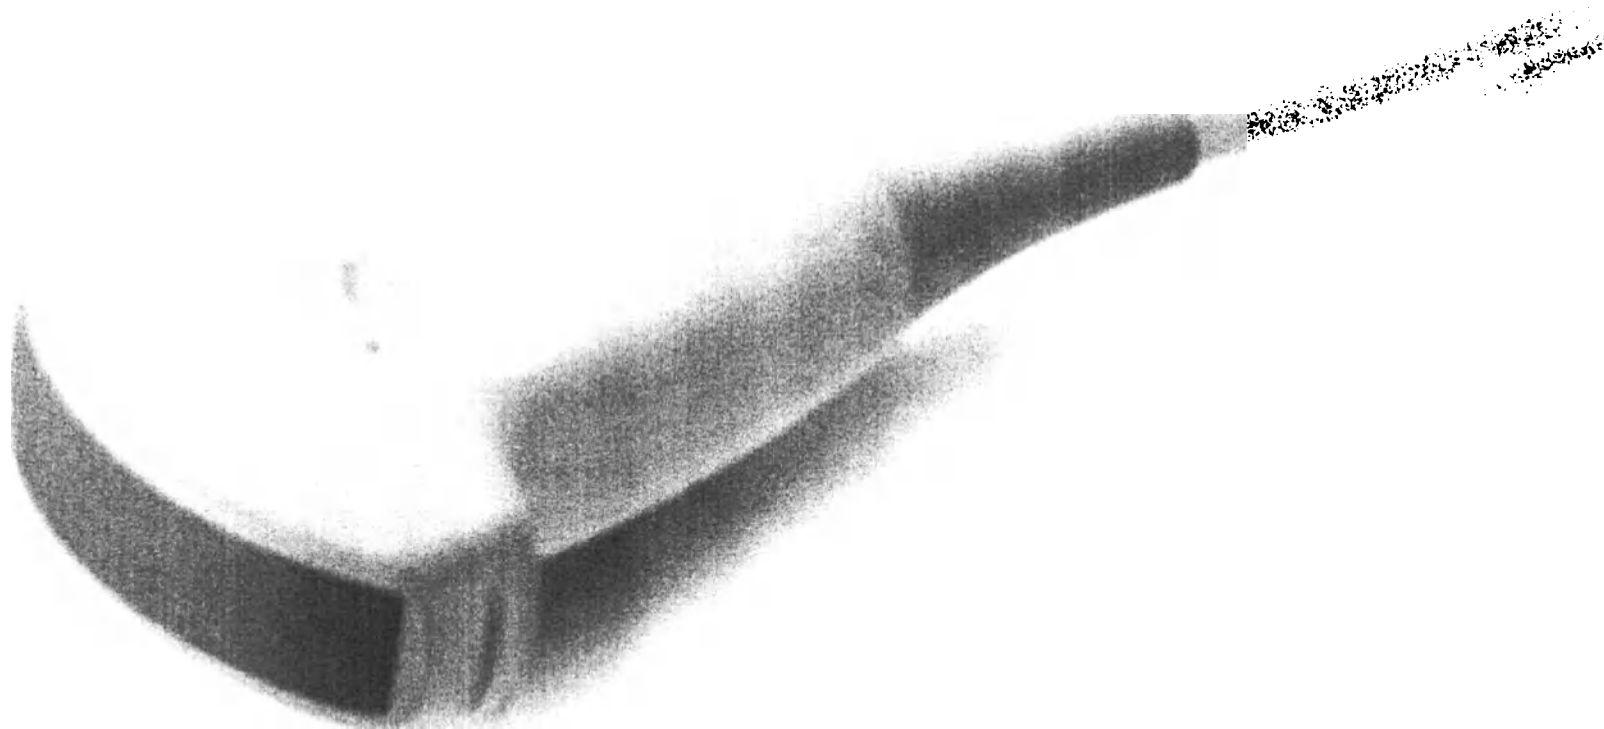


Датчик конвексный С2-8 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017)

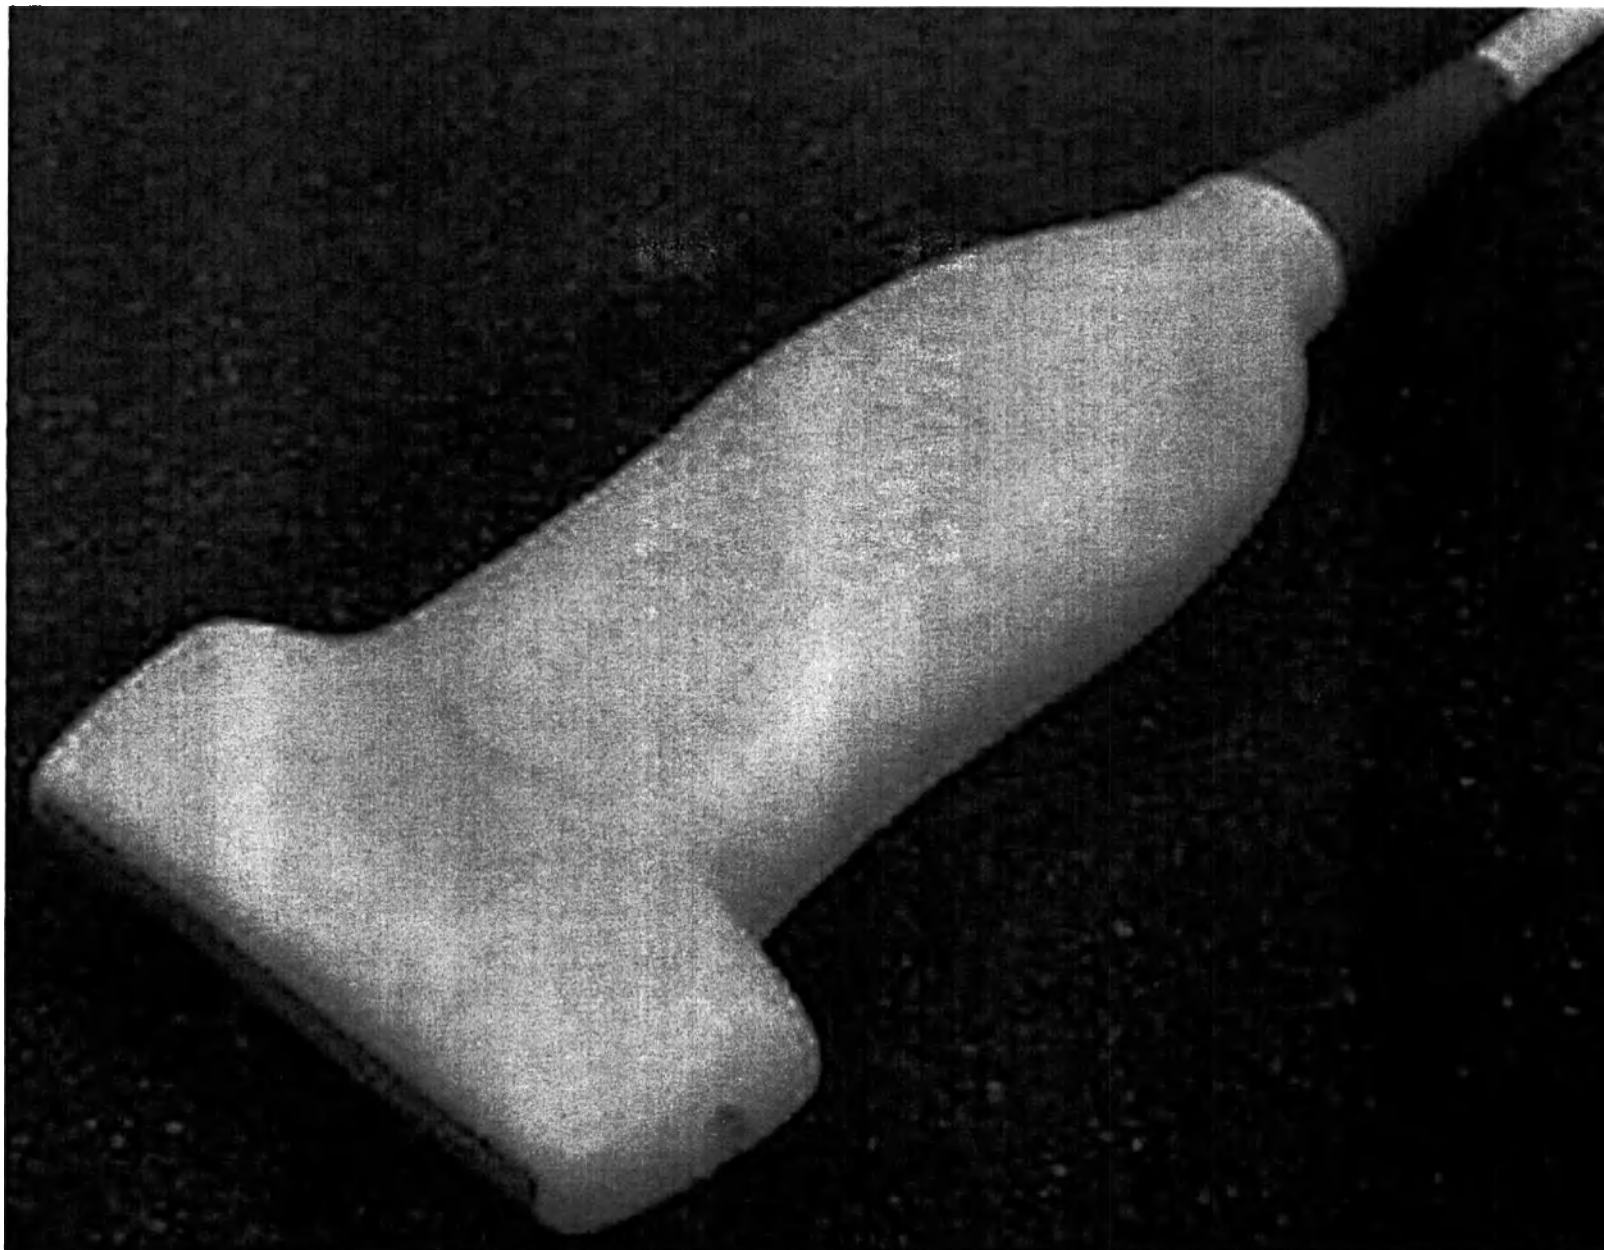


Датчик линейный LNS-12 (№ ФСЗ 2010/06275 от 29.05.2017)

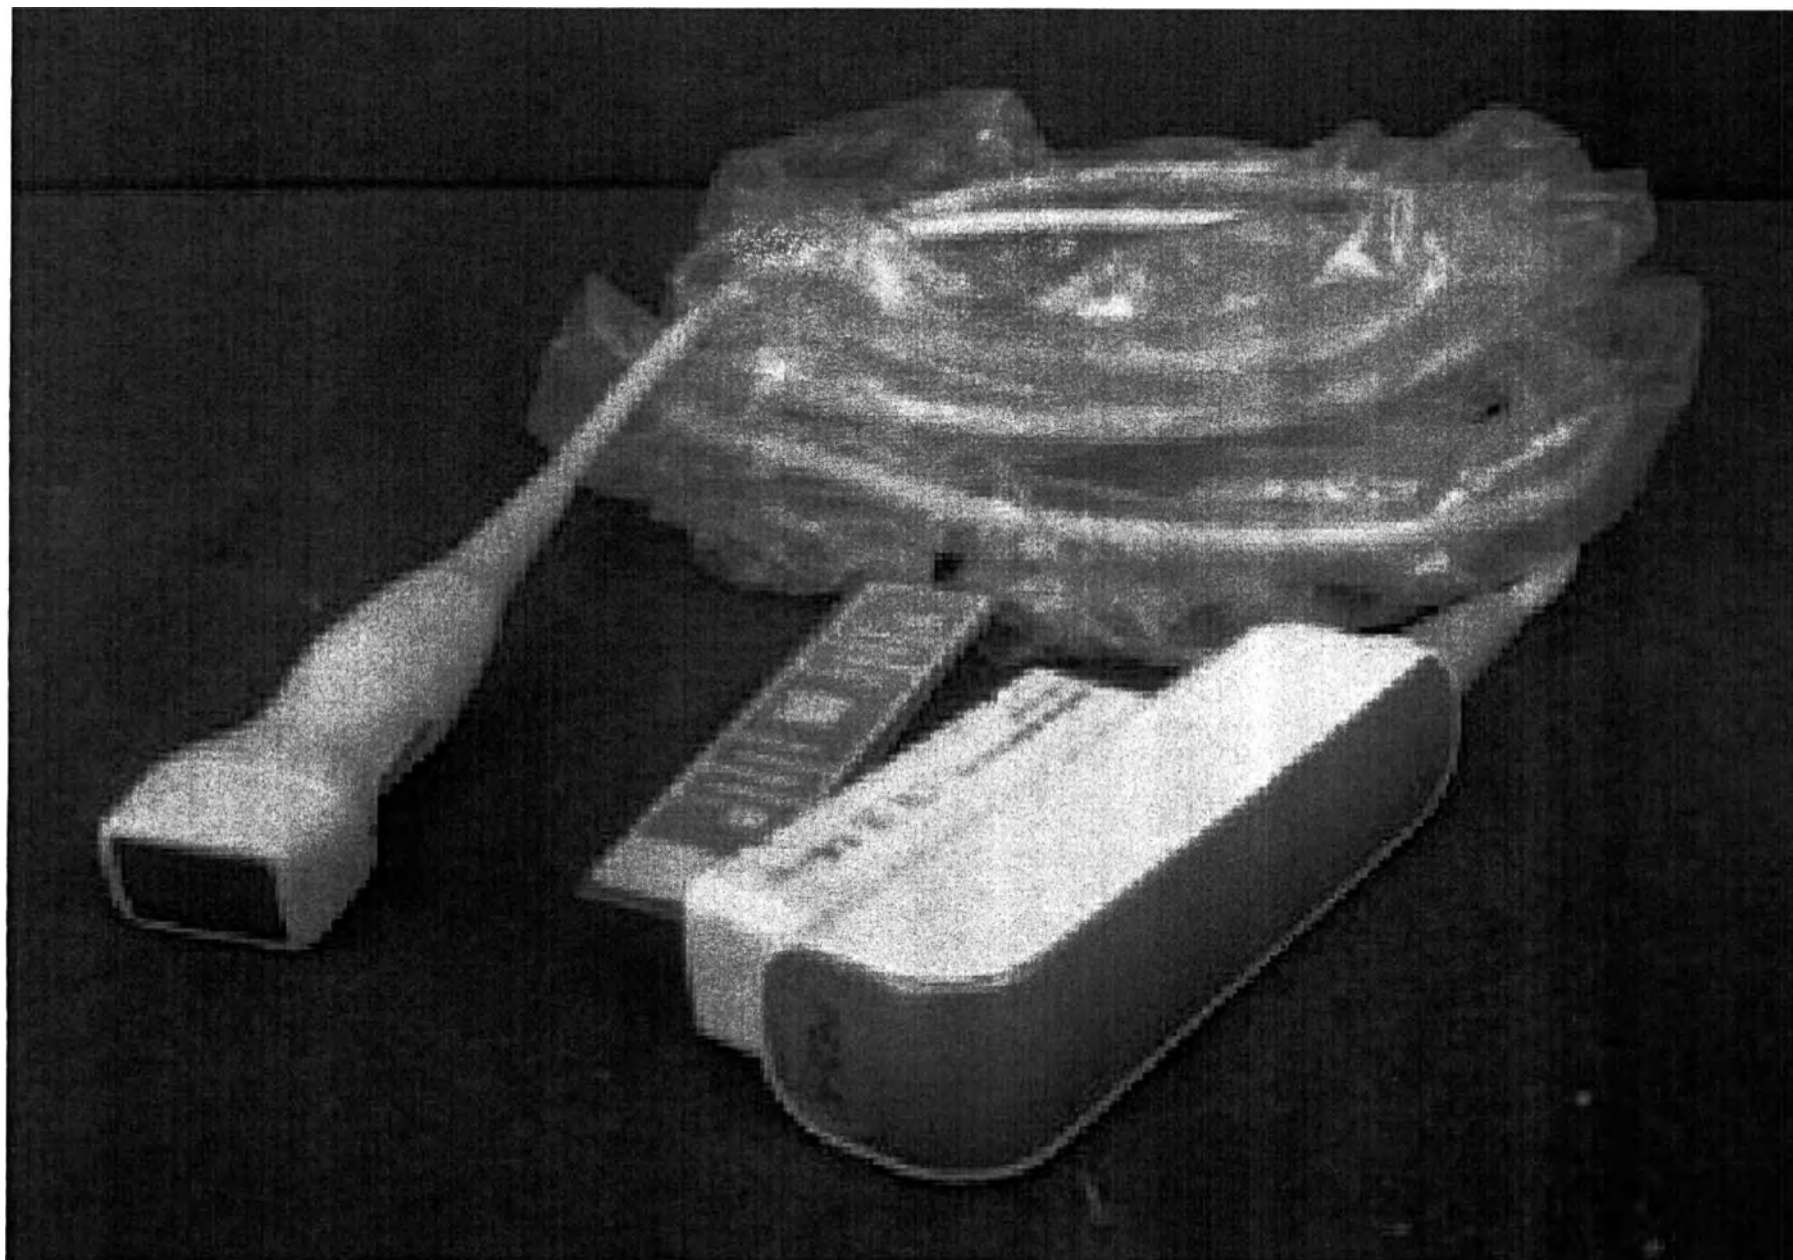


Датчик фазированный PN2-4 (№ РЗН 2020/11652 от 11/08/2020)

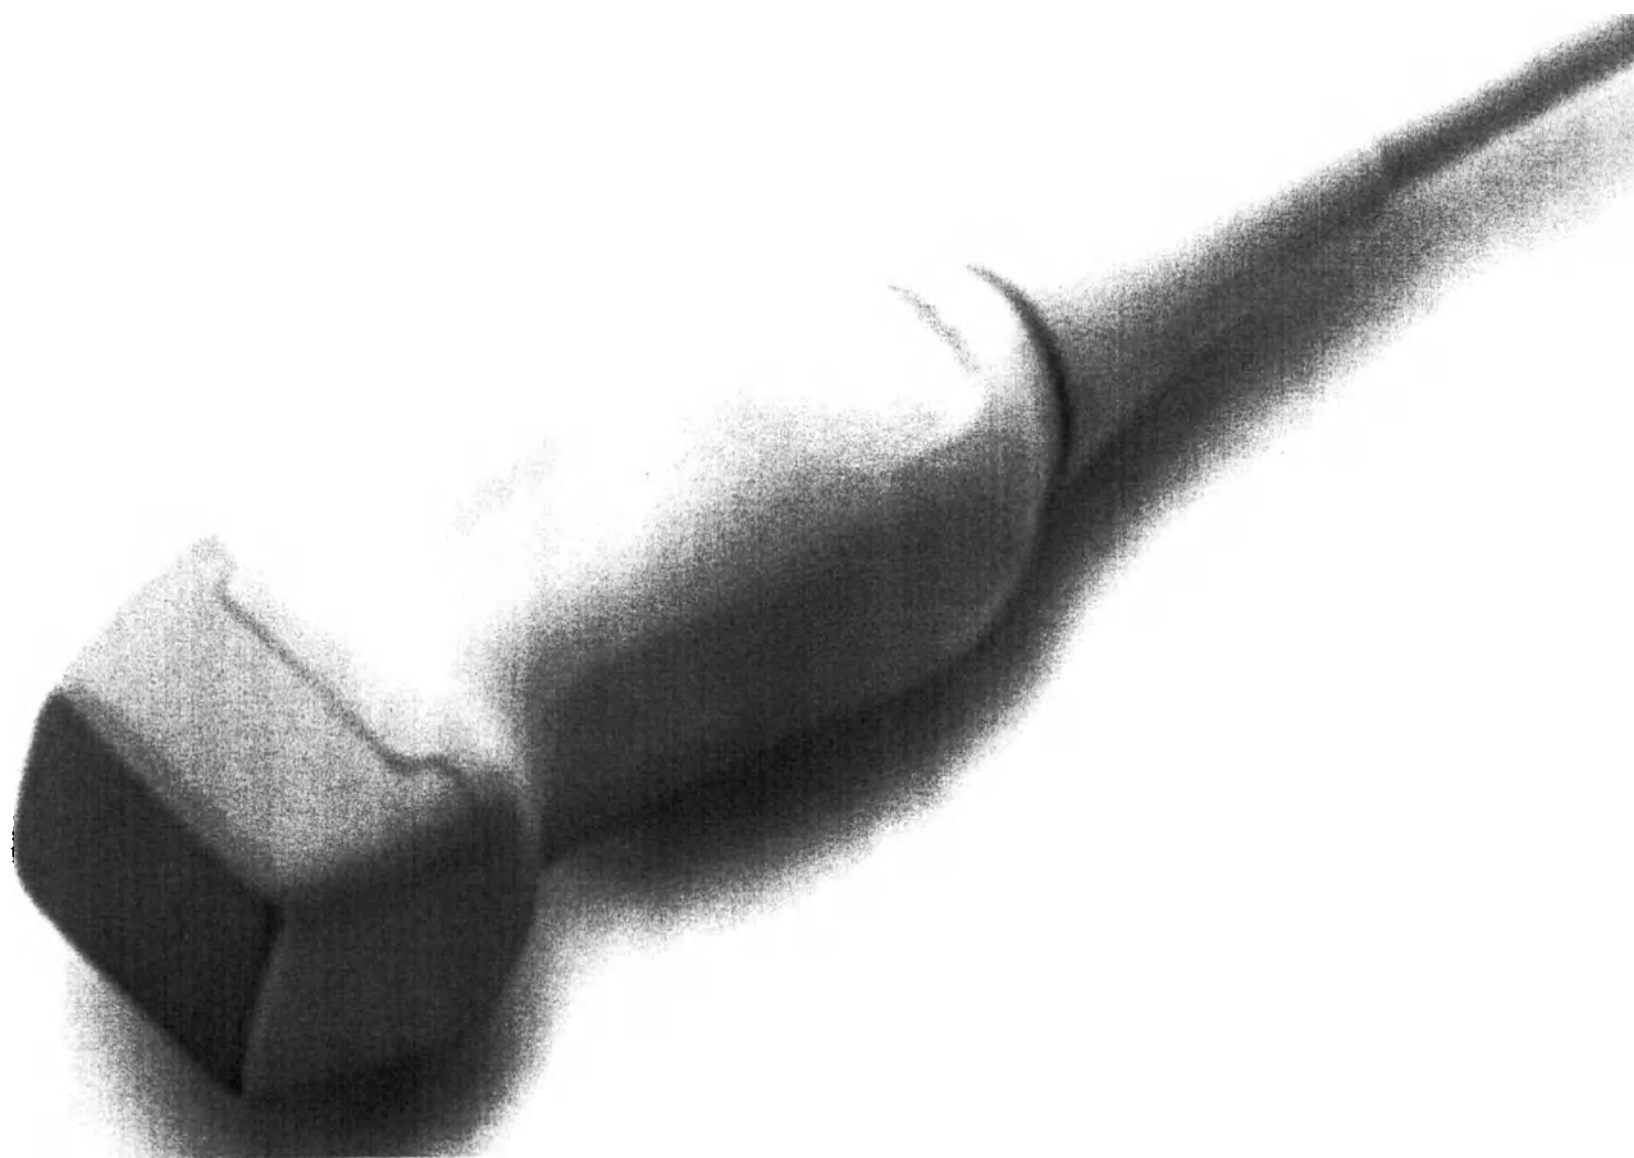


Датчик фазированный SP3-8 (№ РЗН 2020/10698 от 11/06/2020)

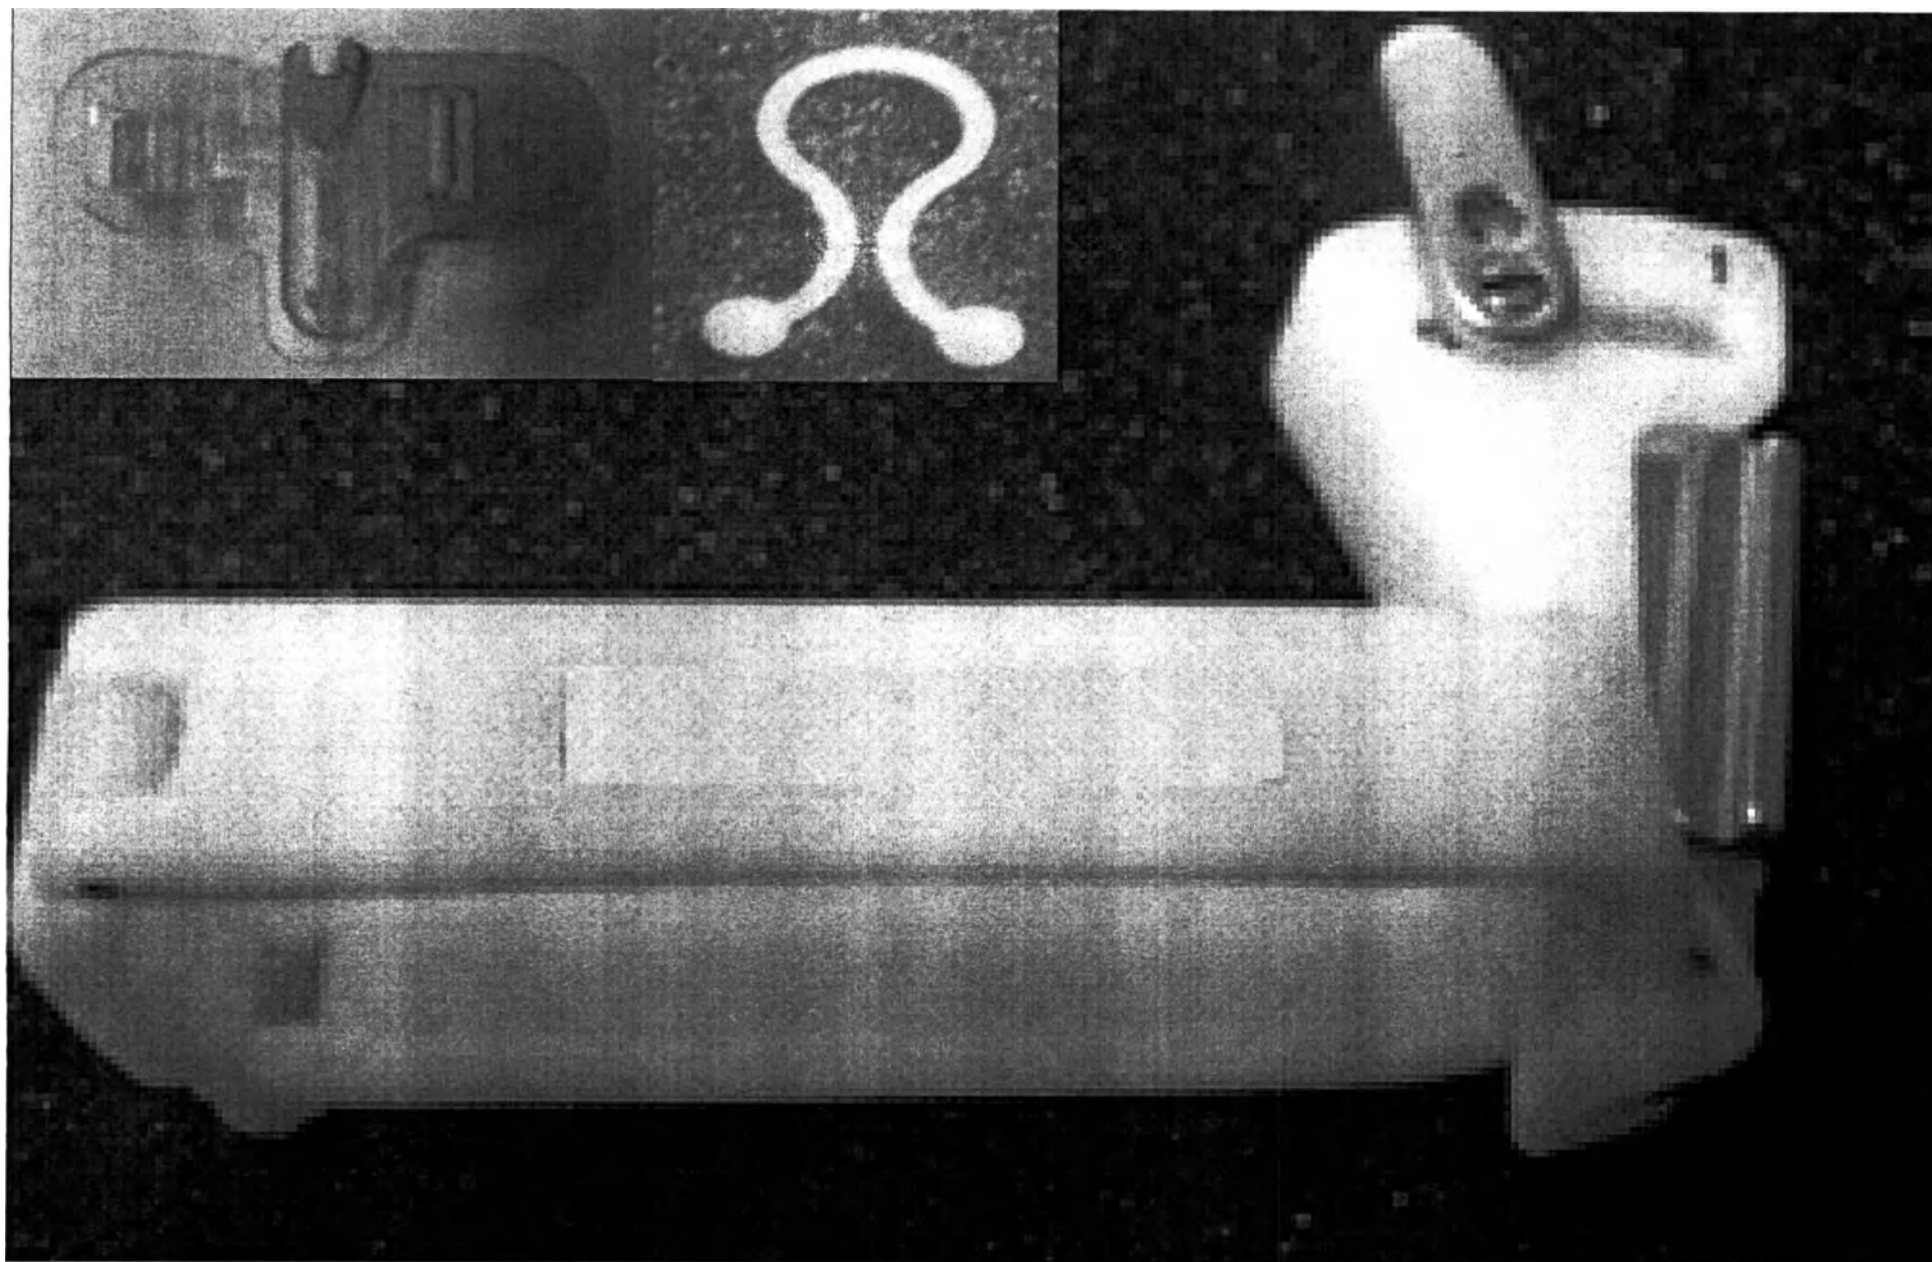


Набор для проведения биопсии , в составе: насадка для биопсии; направляющая иглы; крепление

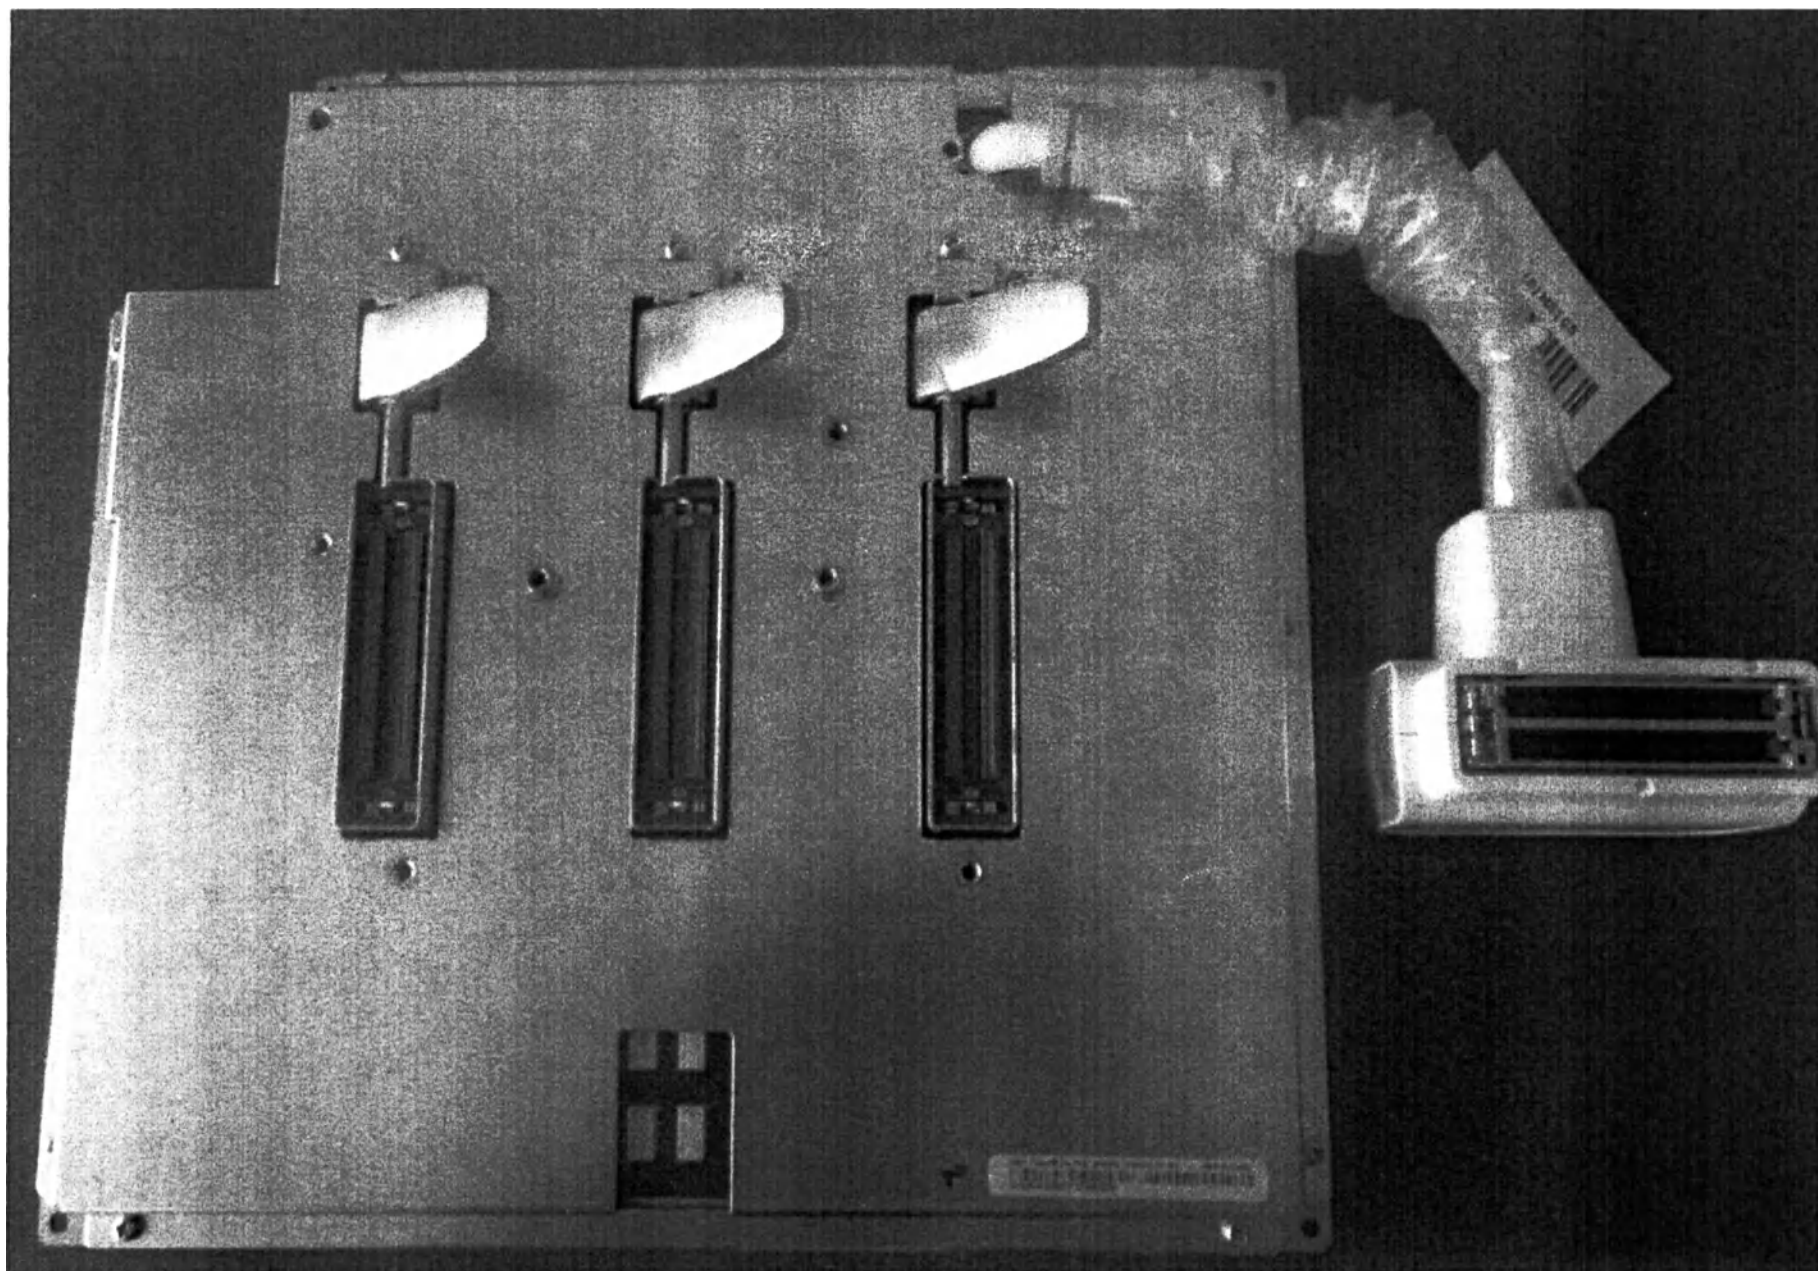


Разветвитель для подключения дополнительных датчиков

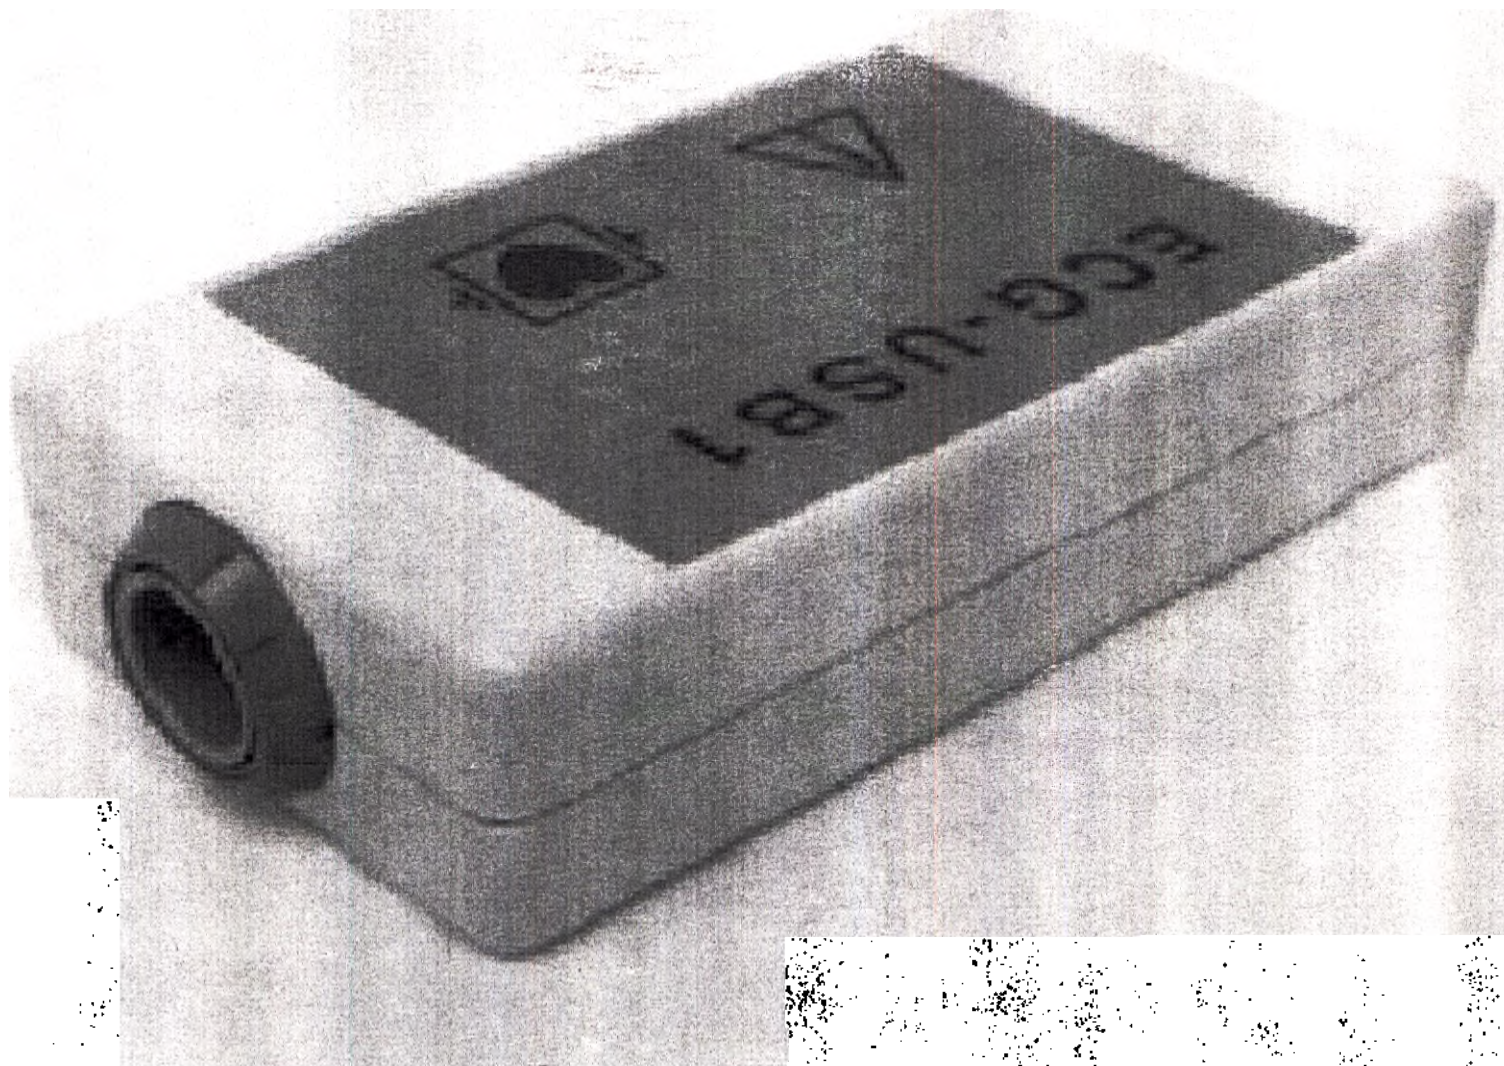


Модуль ЭКГ

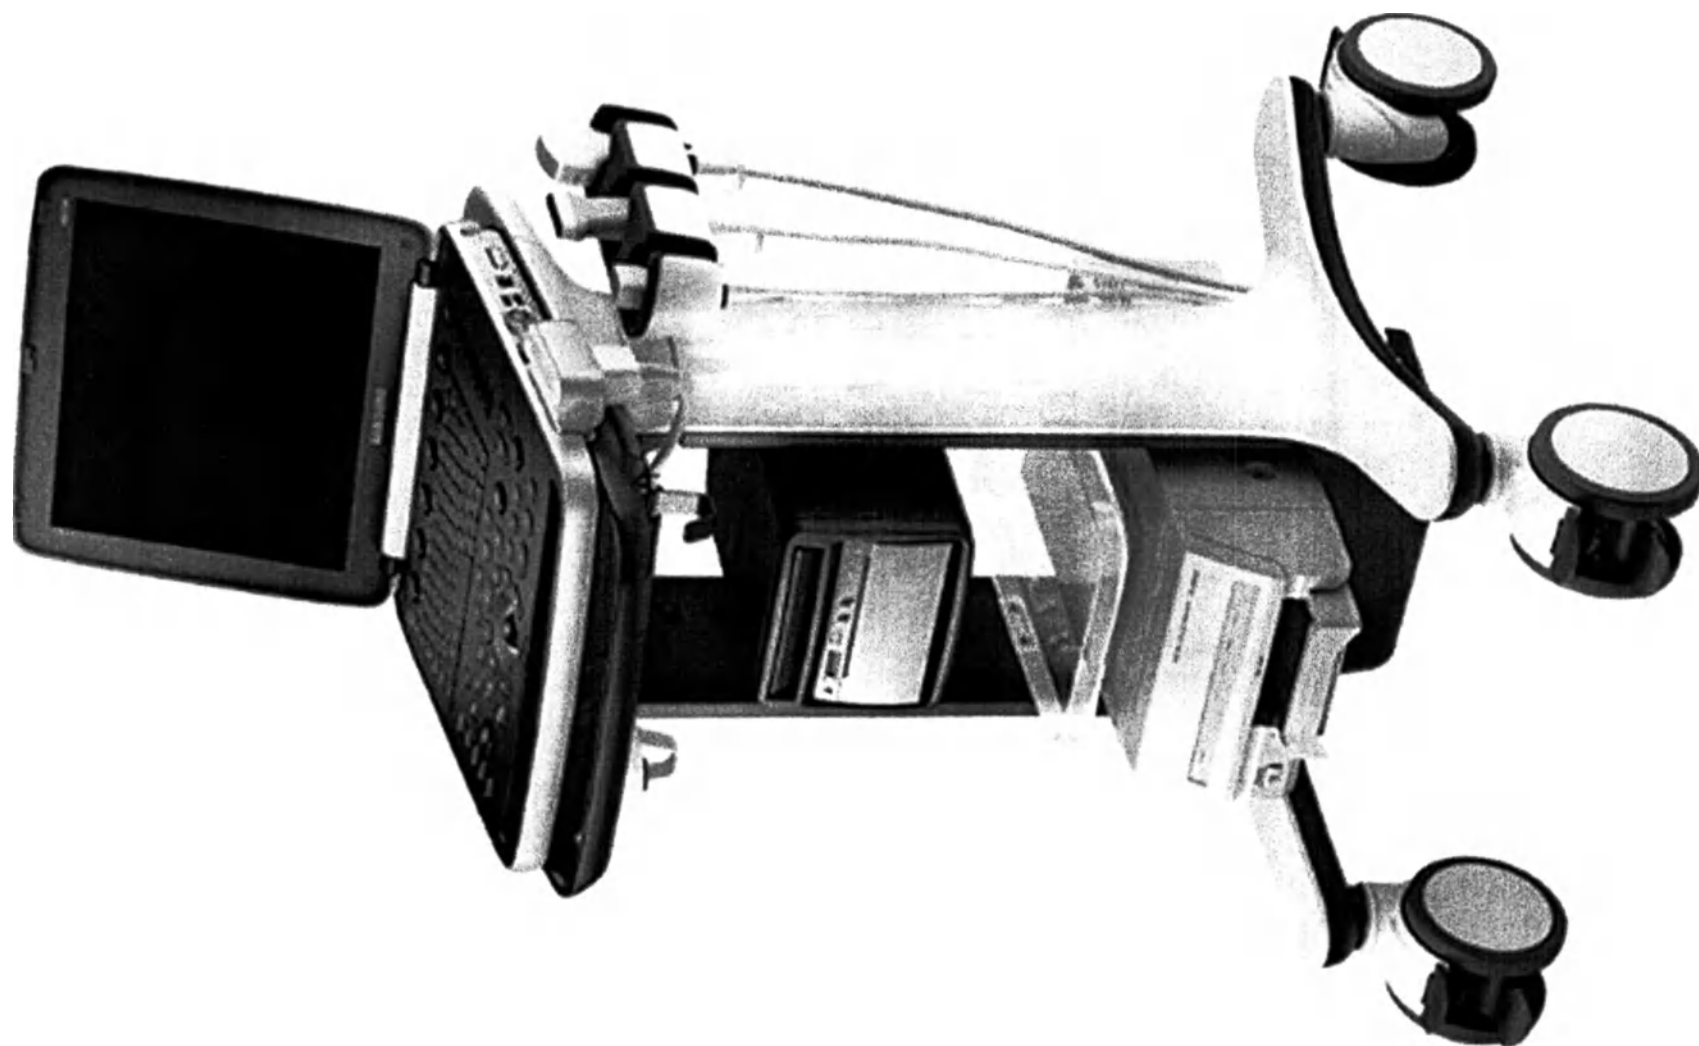


Приборная тележка

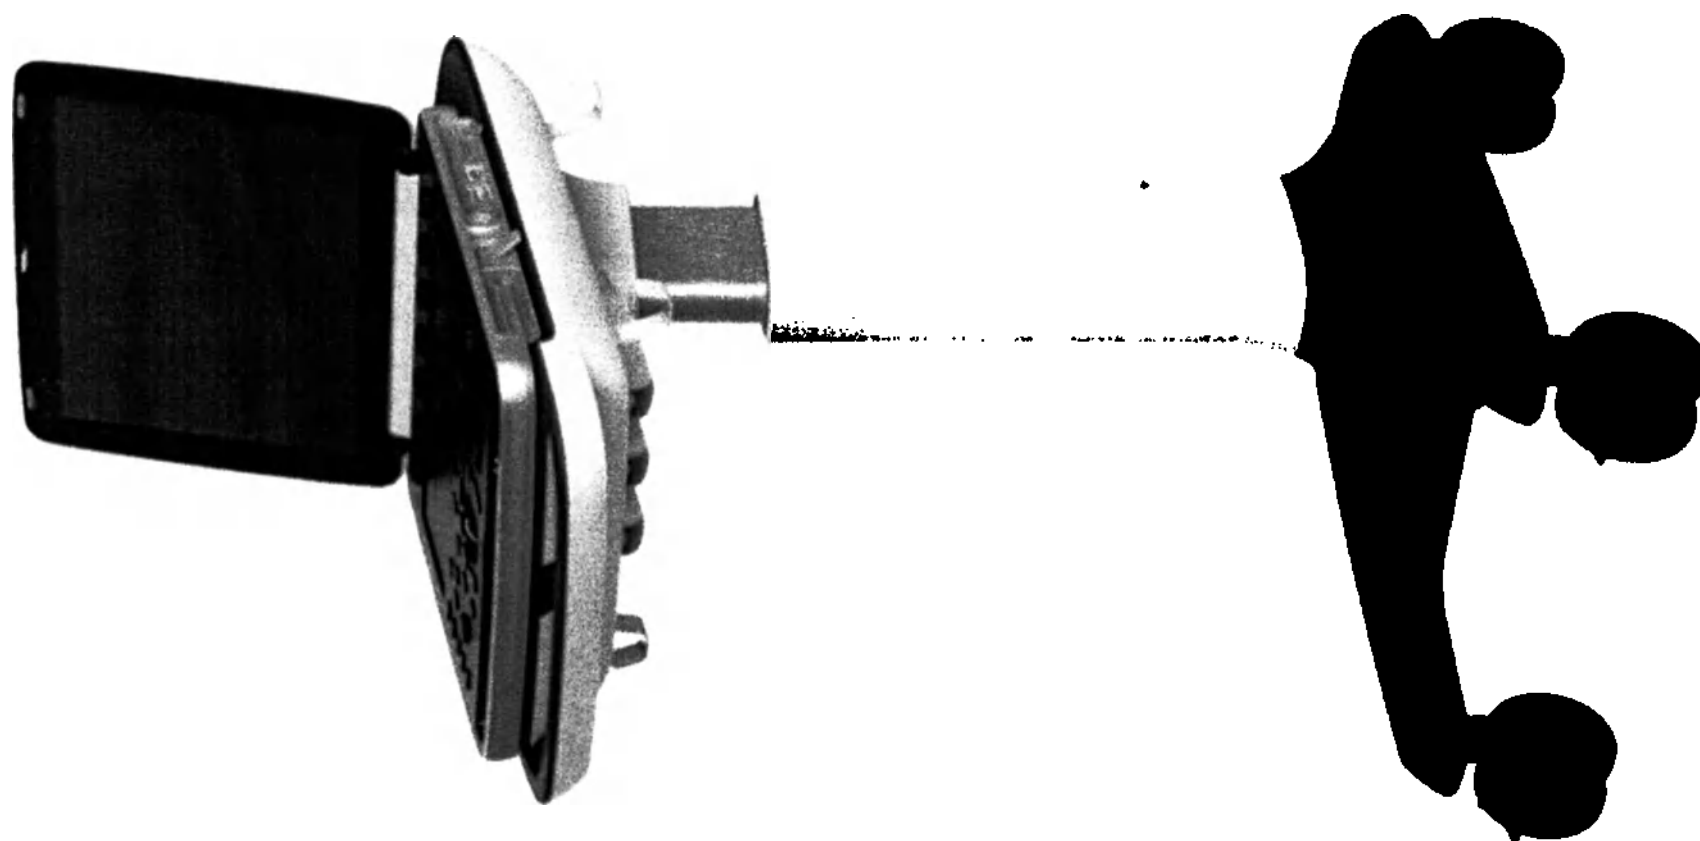

Стандартная мобильная тележка

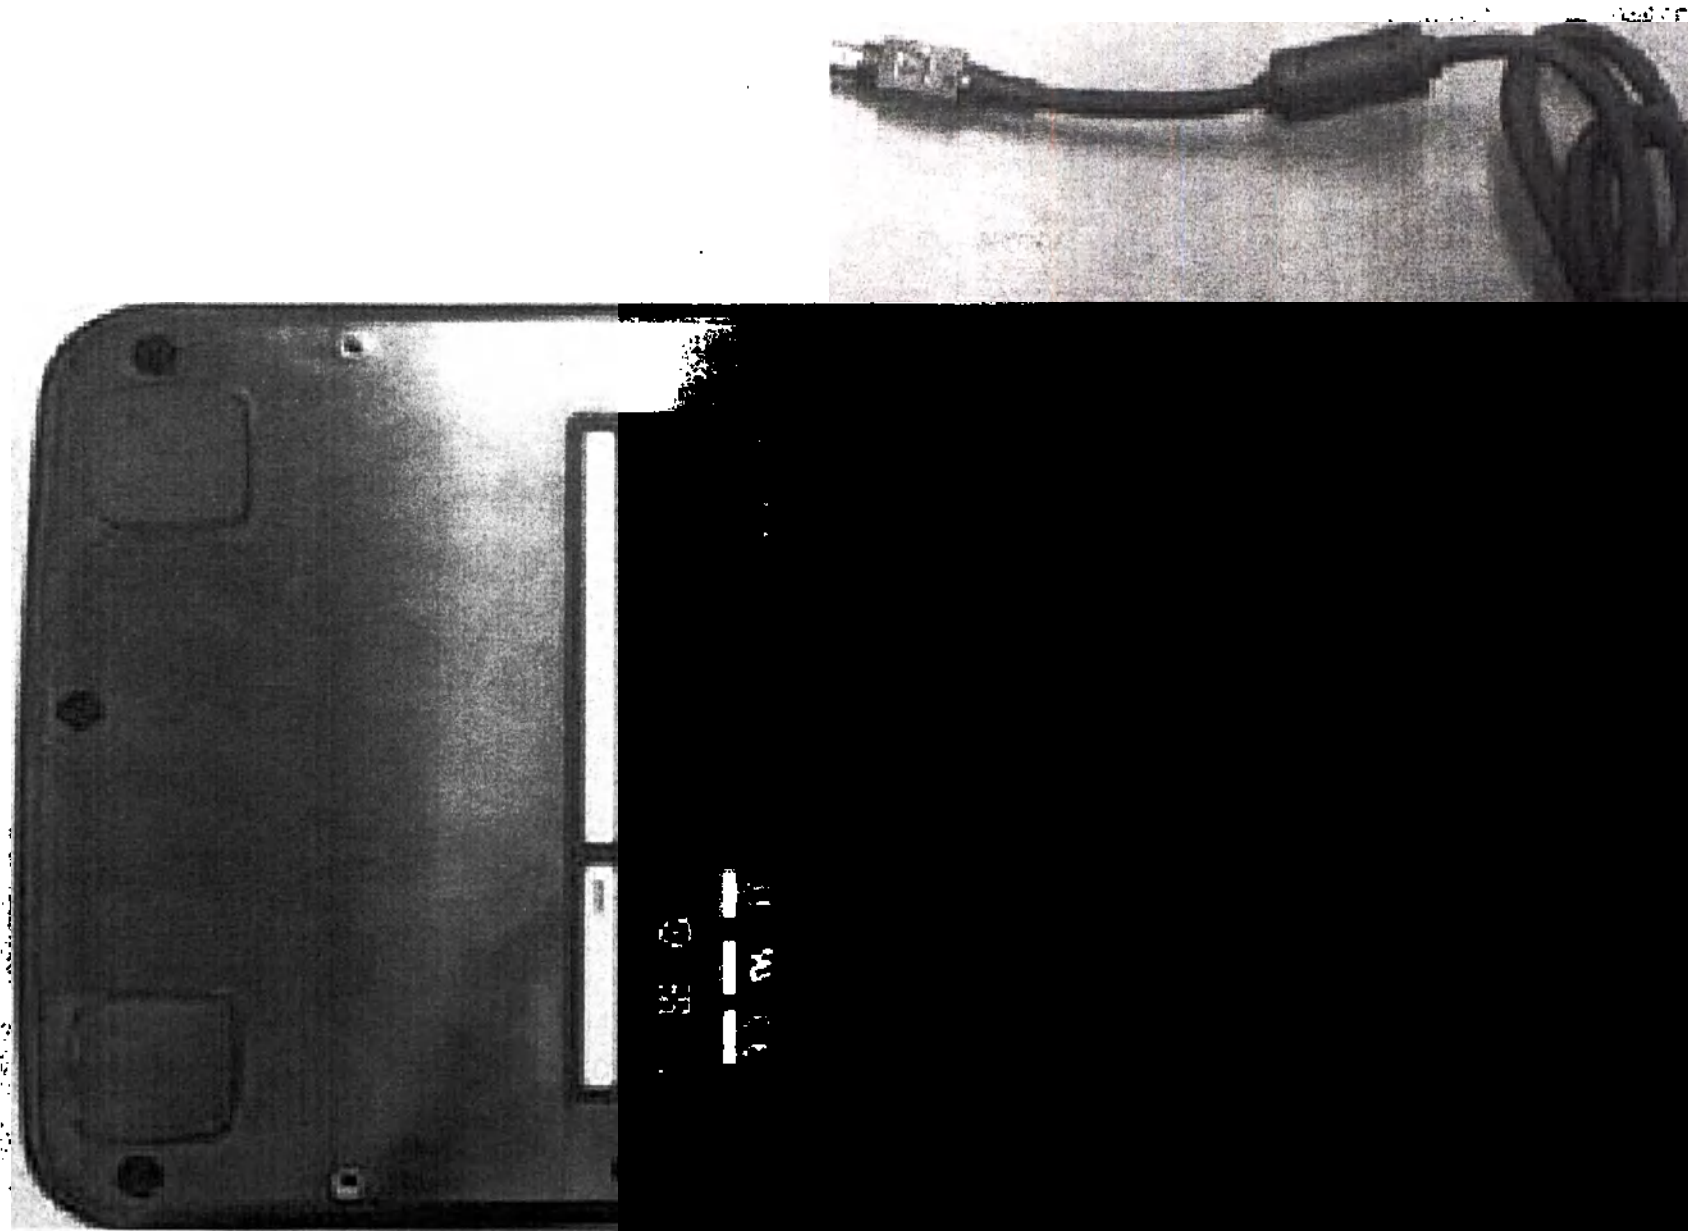


Дополнительная аккумуляторная батарея

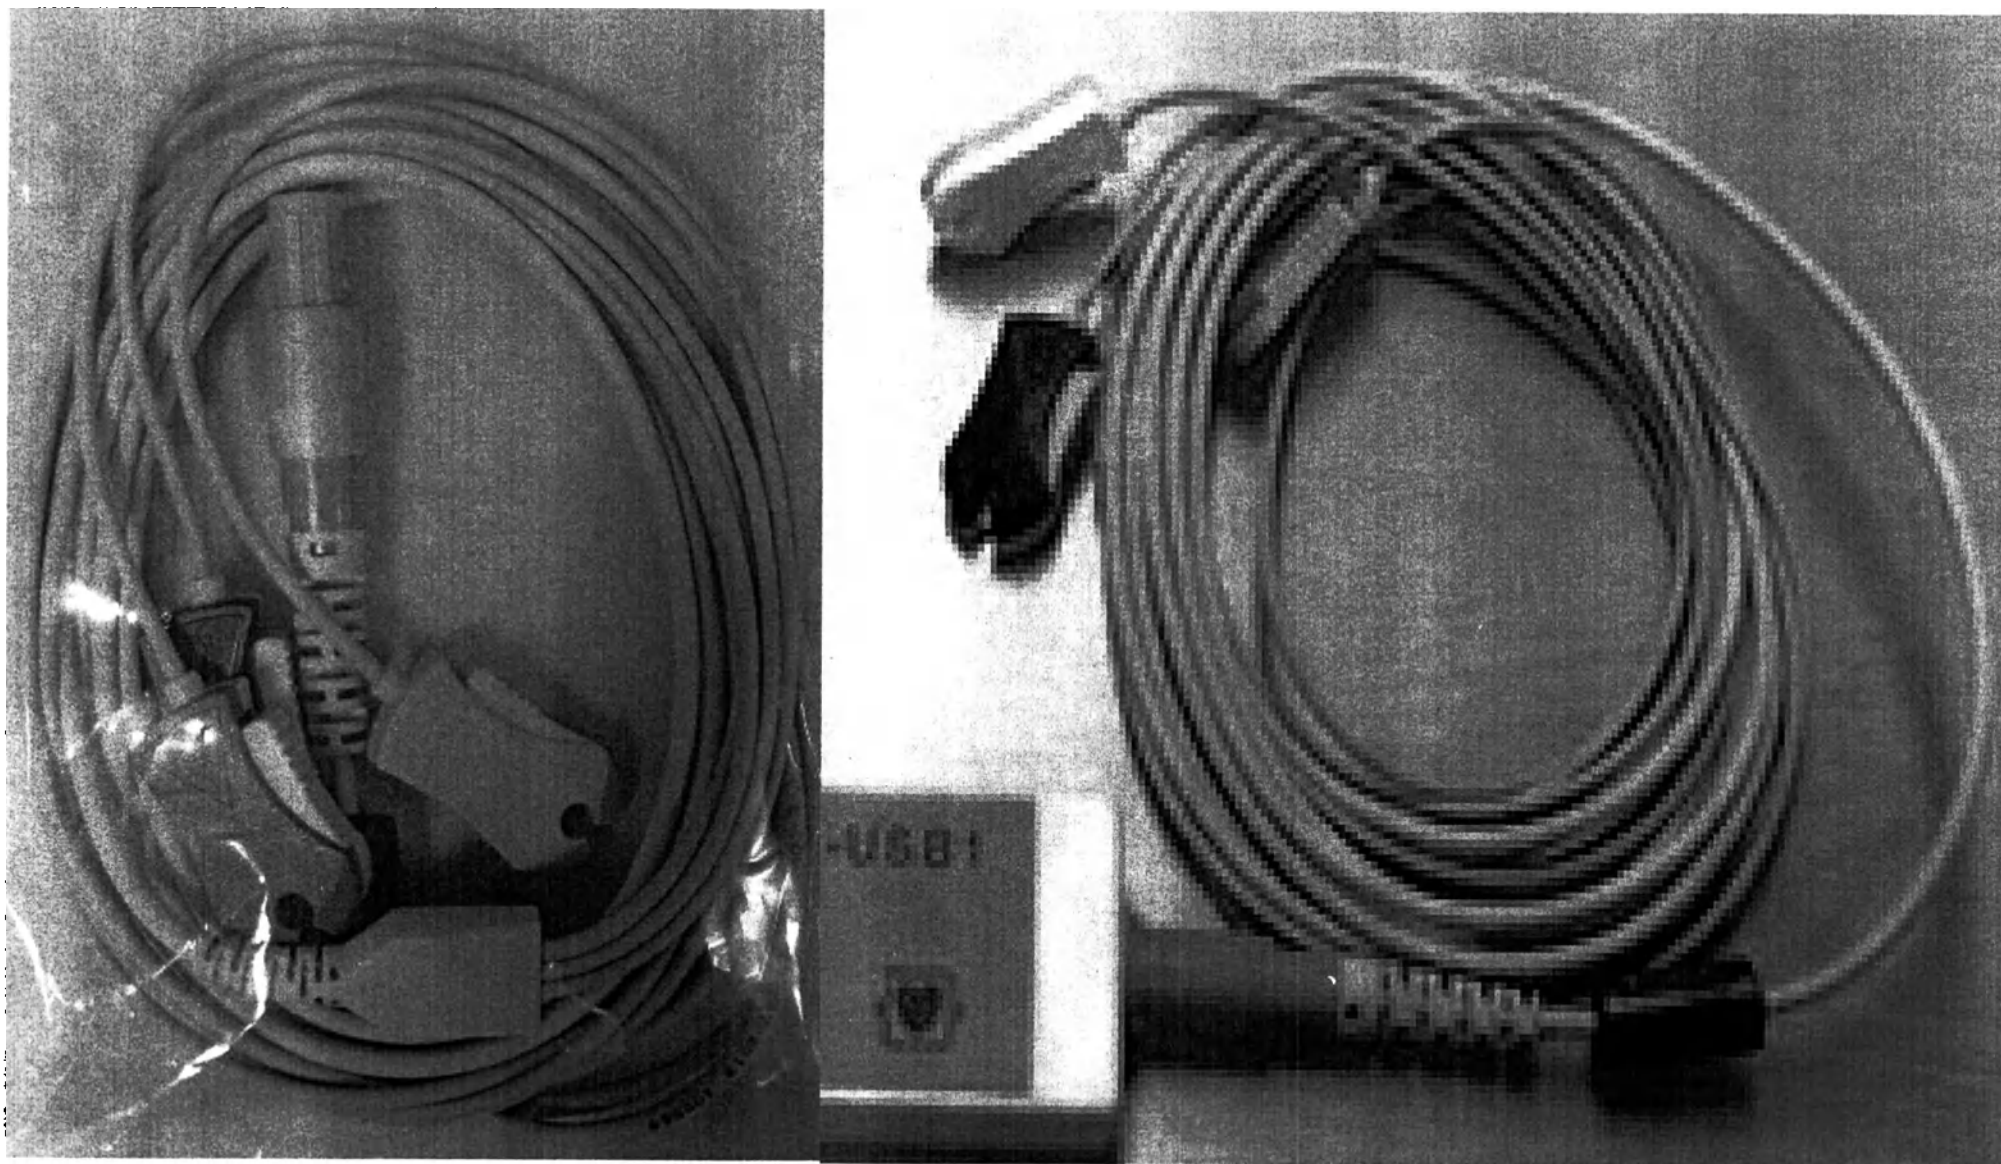


Соединительные провода и кабели




Ножной переключатель (№ РЗН 2015/3259 от 28.10.2015)

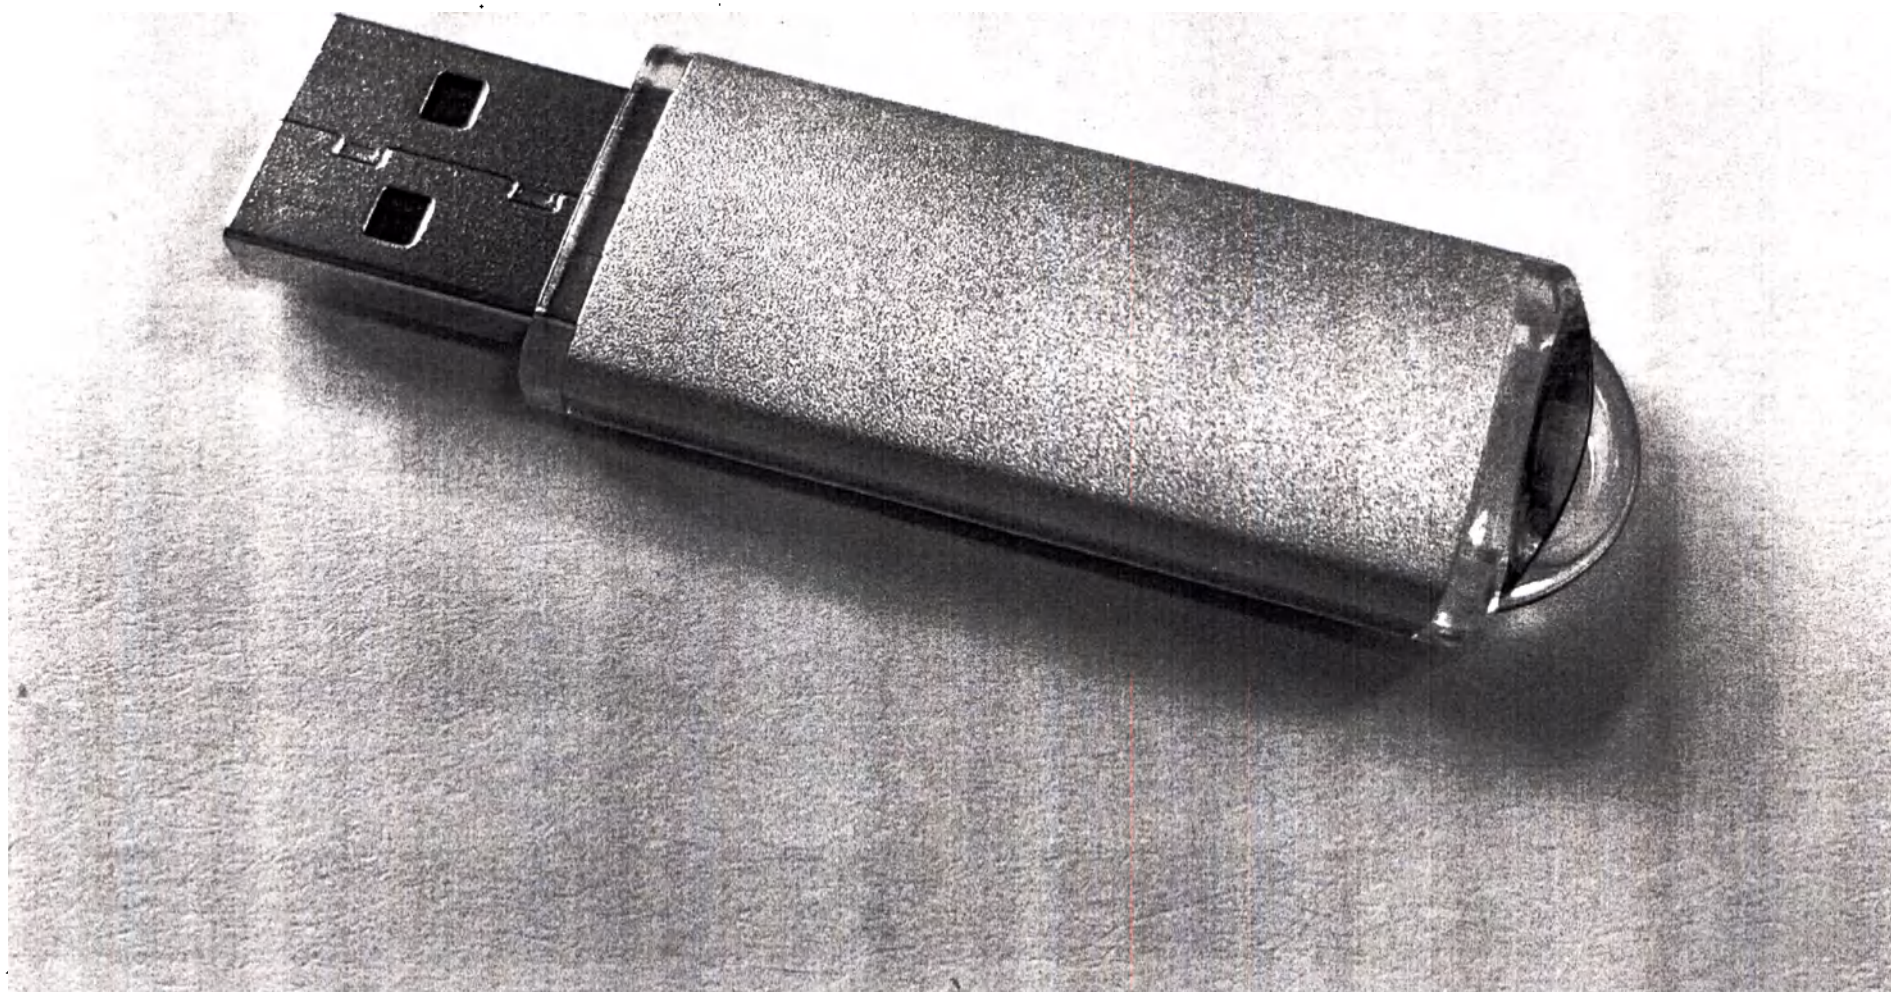


Флеш-накопитель

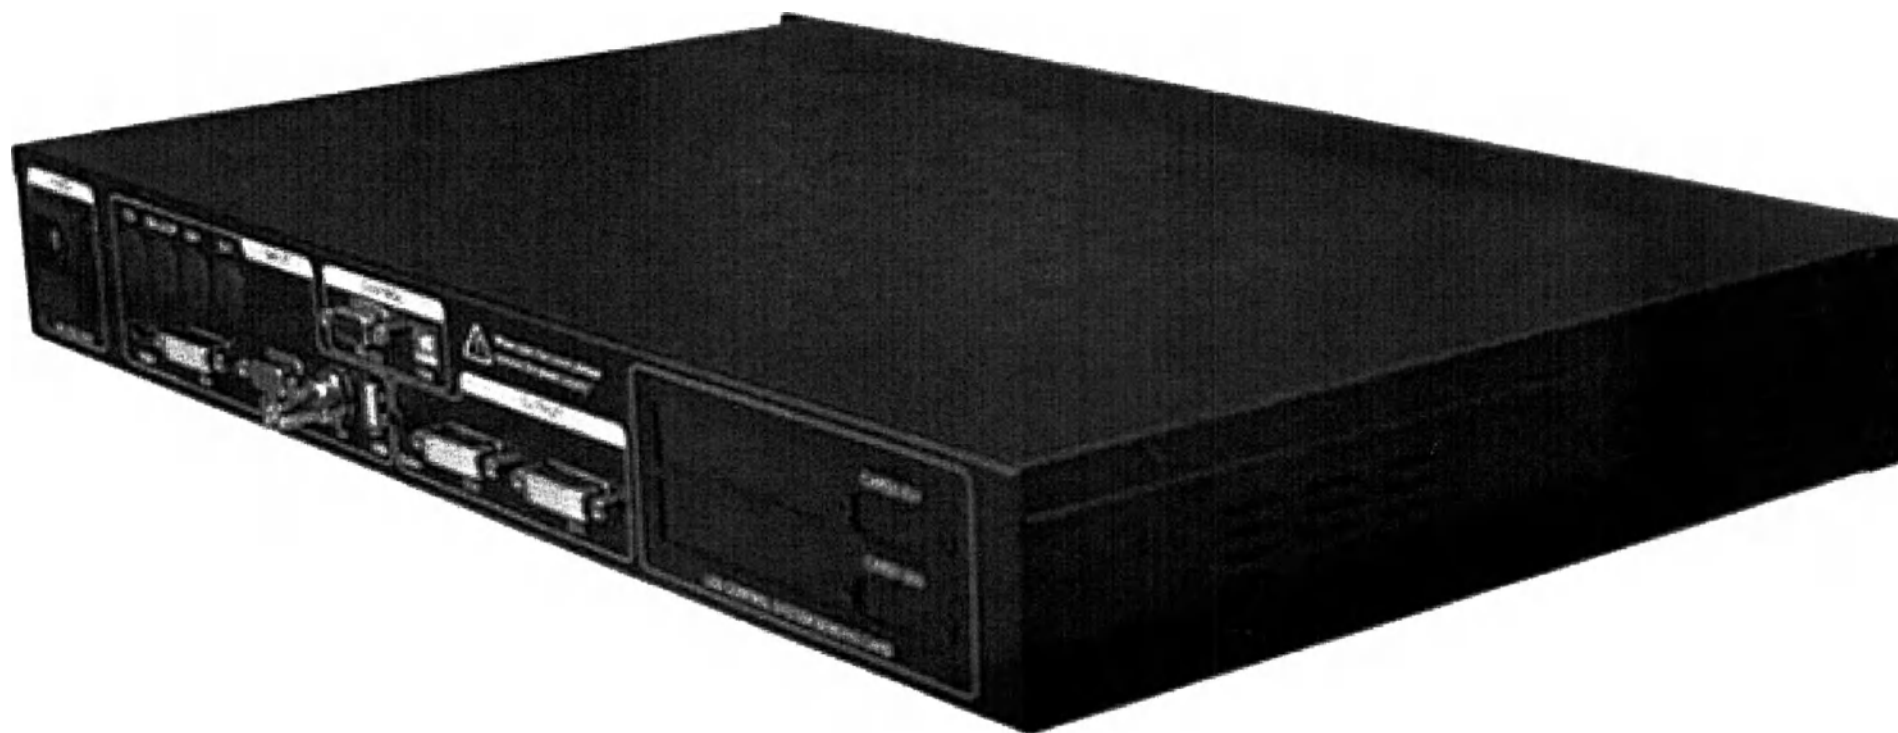


Устройство видеовывода

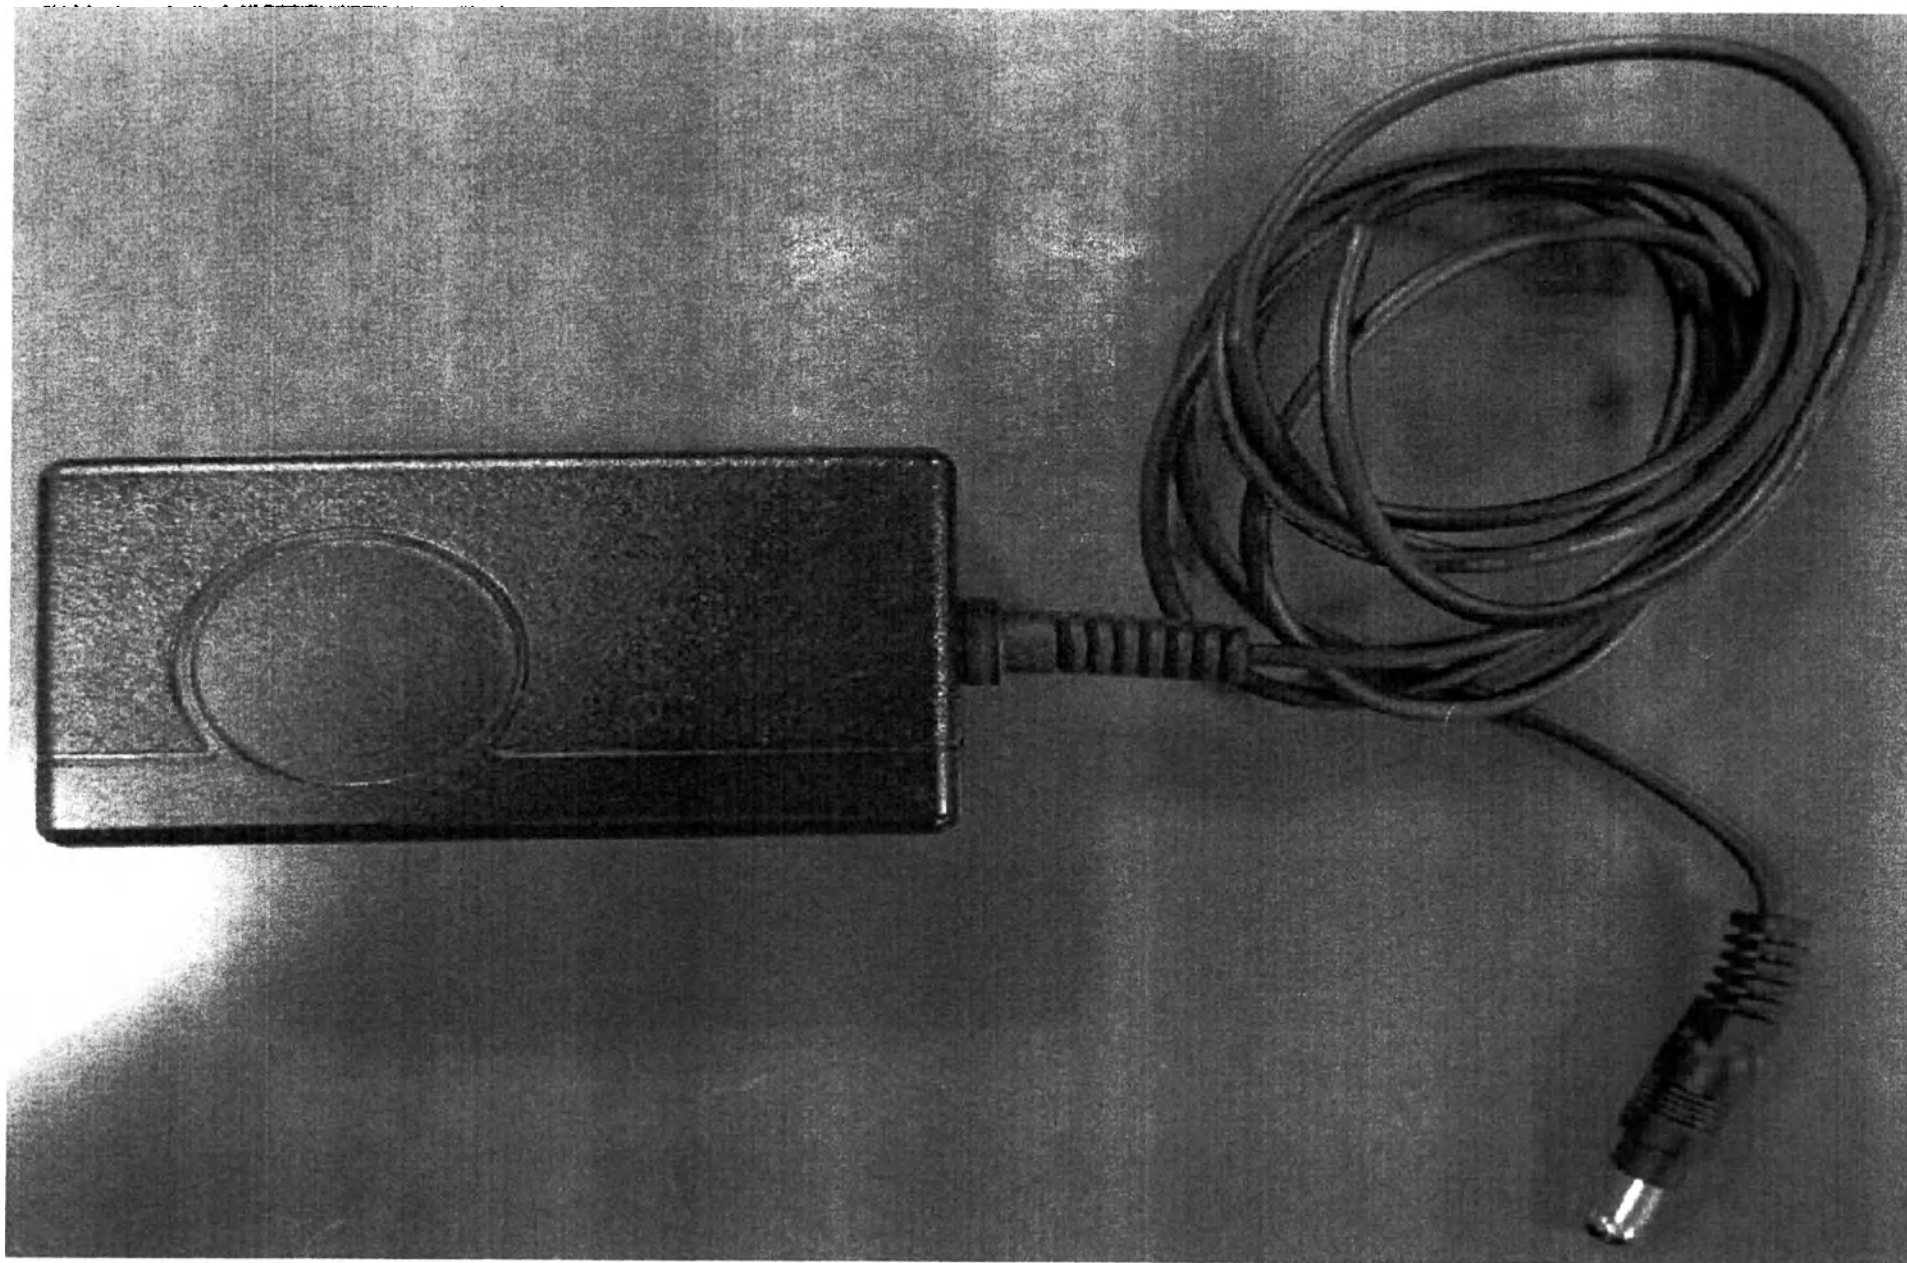


Адаптер переменного тока

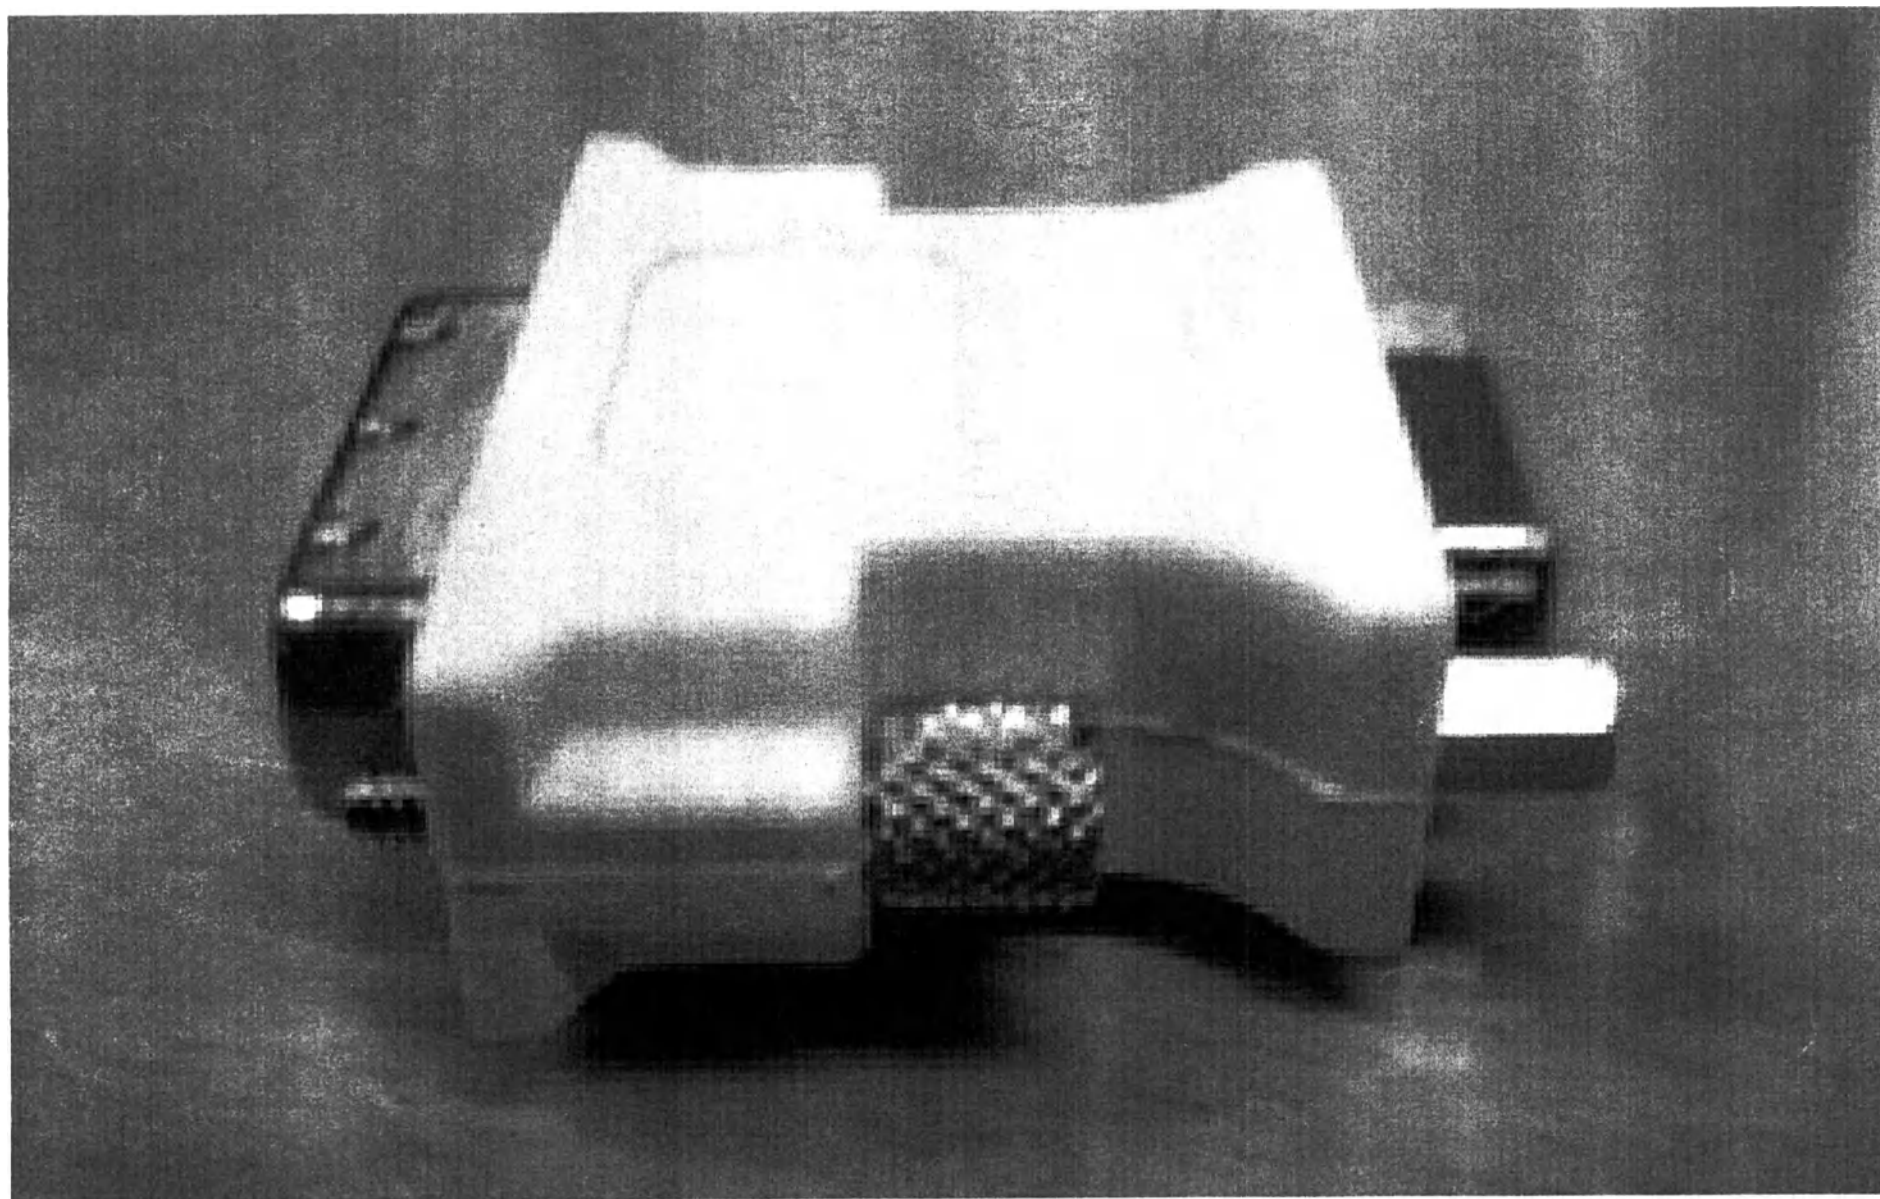

Соединитель

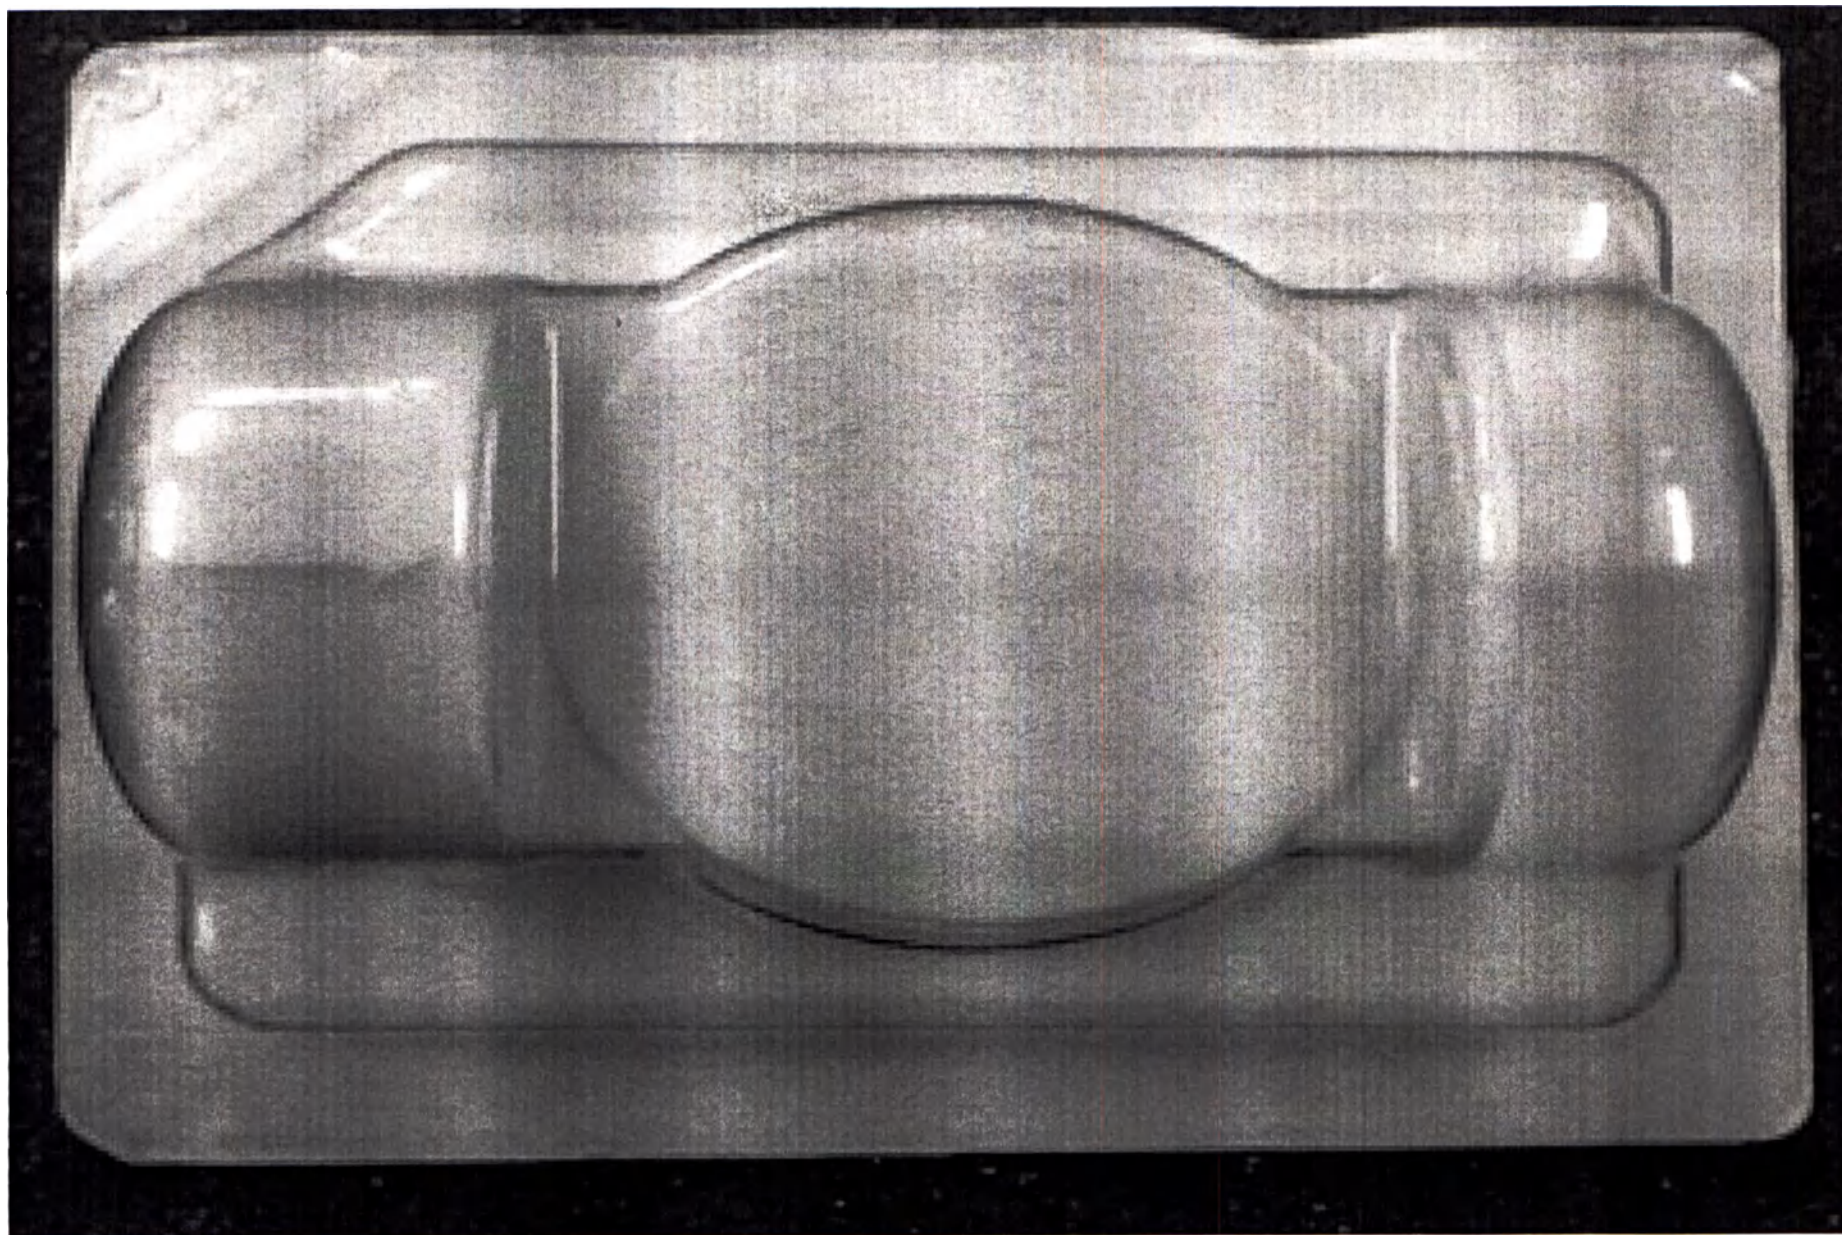

Генератор магнитного поля

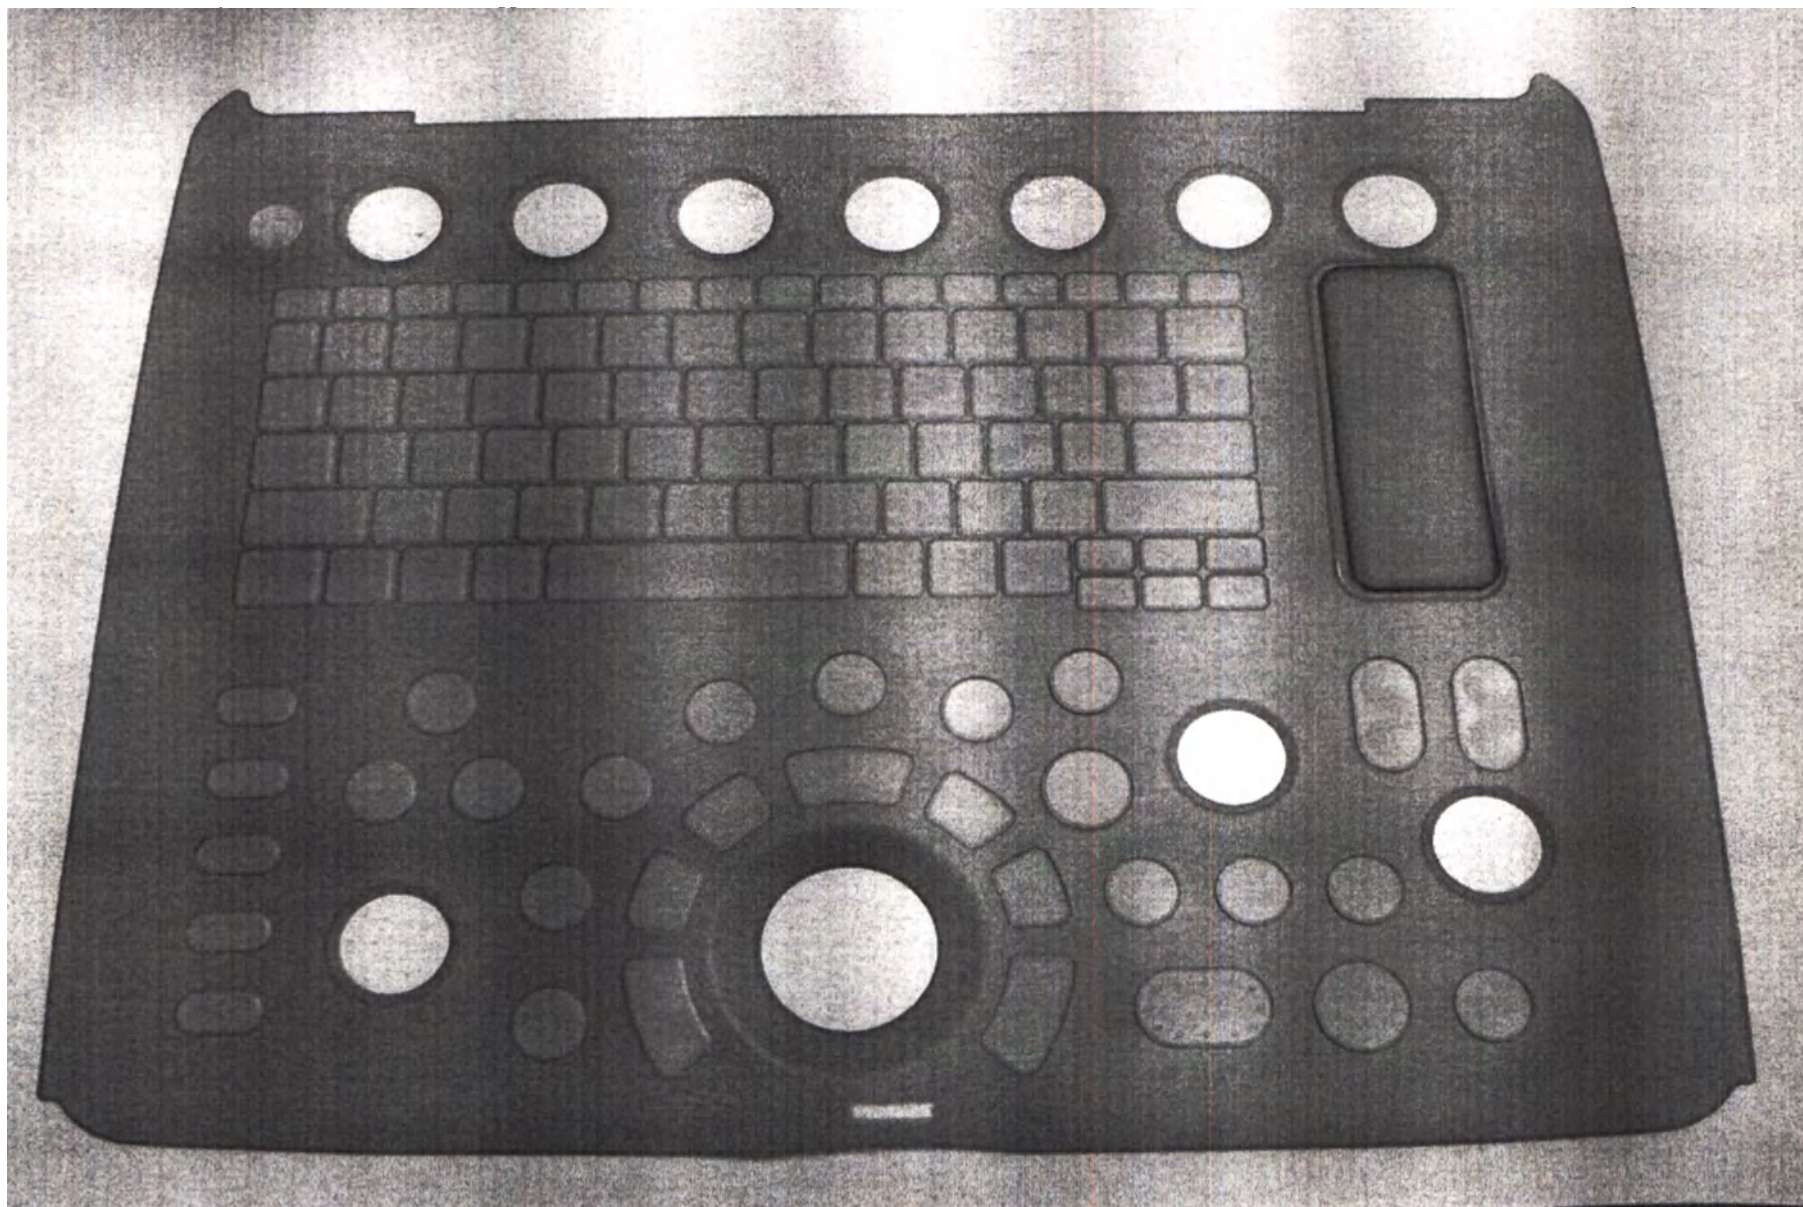

Накладка силиконовая на клавиатуру (CP skin)



Сумка транспортировочная


Ультразвуковой диагностический аппарат
HM70A-RUS, HM70A EXPERT-RUS,
с принадлежностями

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
(САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

Лицензионный ключ для активации функции AntiVirus

454101364AD9E1A4F42A

Лицензионный ключ для активации функций

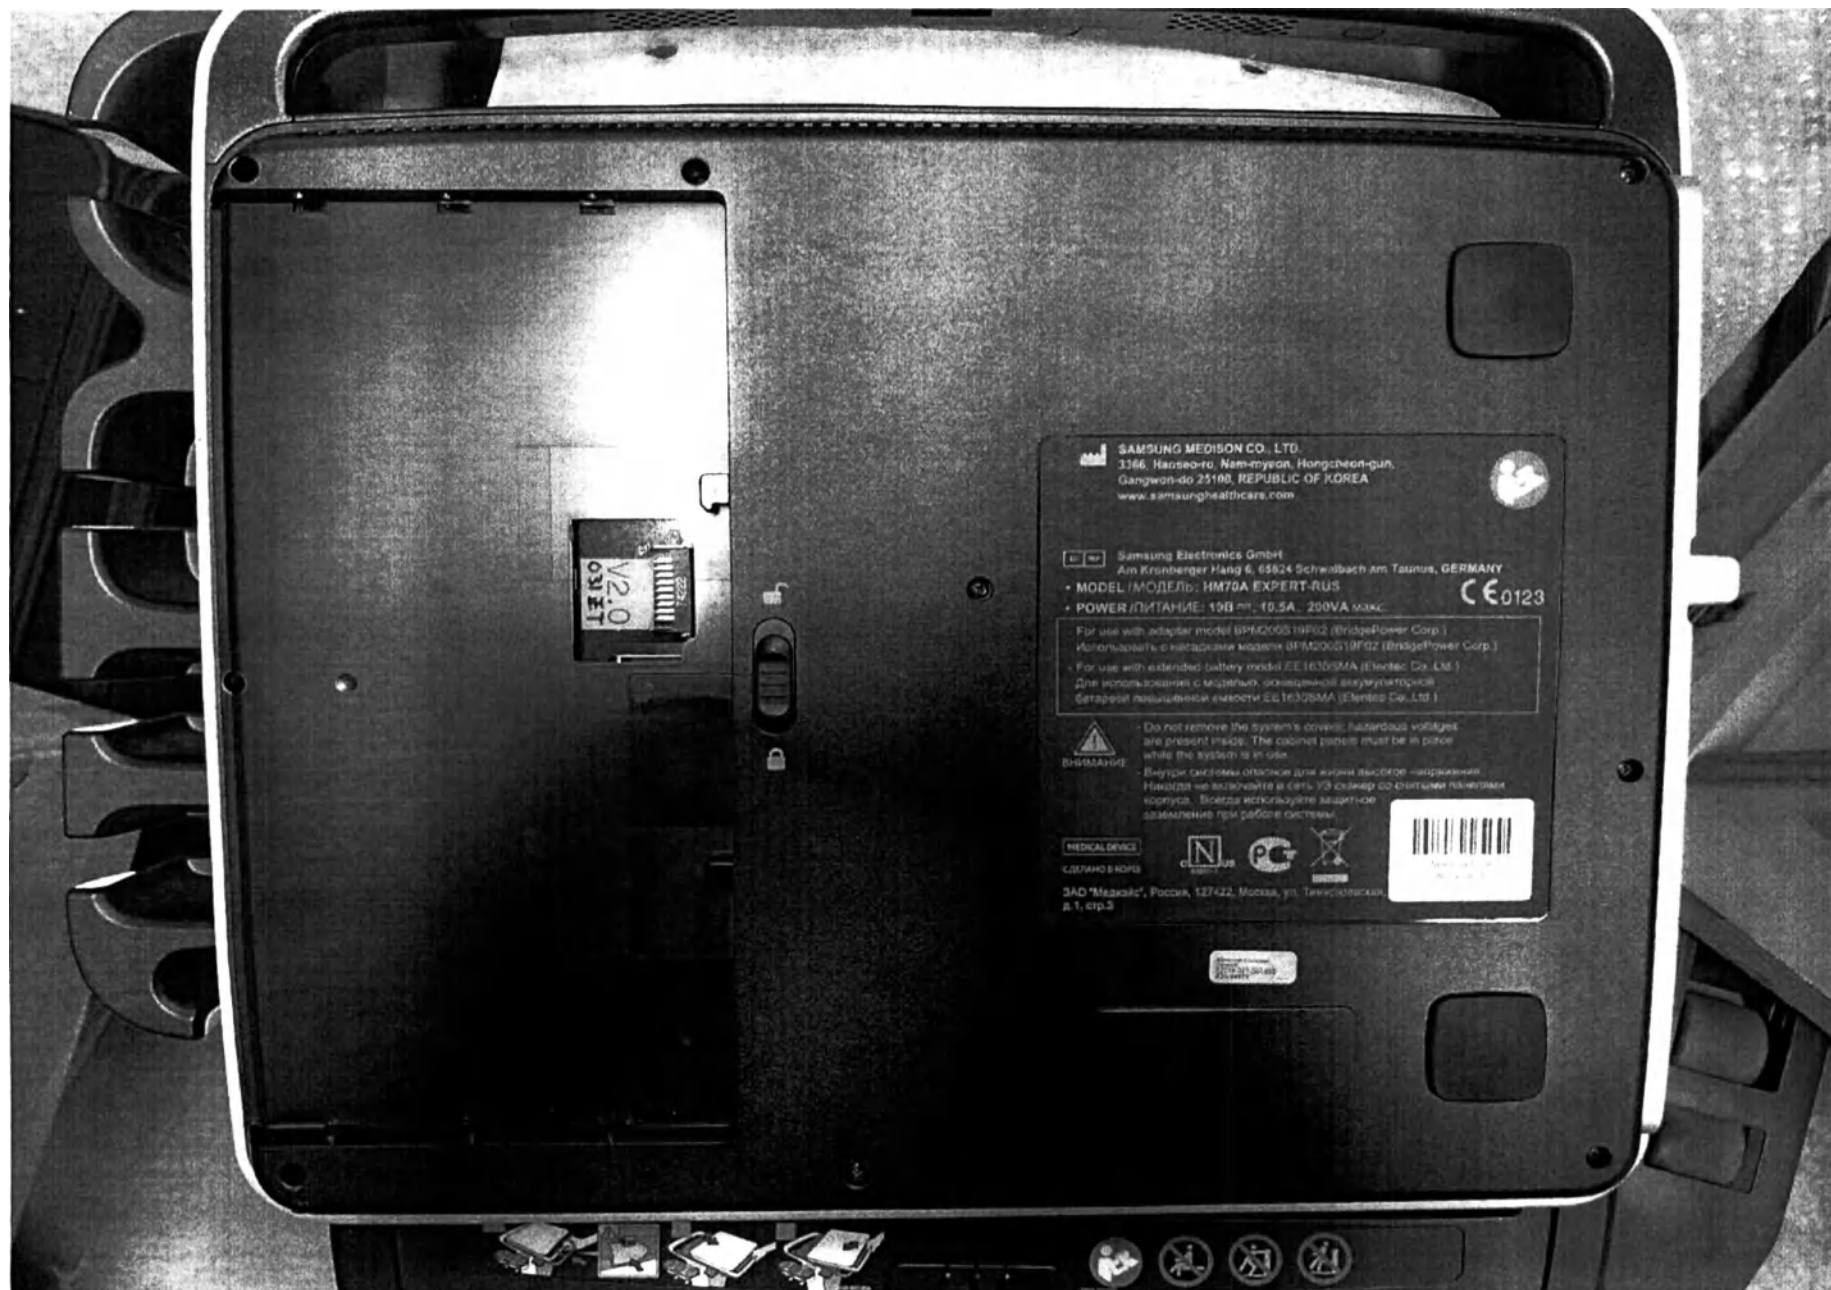

Маркировка изделия



SAMSUNG MEDISON CO., LTD.

3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do 25108,
REPUBLIC OF KOREA

www.samsunghealthcare.com

MEDICAL DEVICE



Samsung Electronics GmbH

Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY

CE 0123

· MODEL/МОДЕЛЬ: HM70 EVO-RUS

· POWER/ПИТАНИЕ: 19В ~~, 10.5A, 200VA макс.

· Adaptor: BPM200S19F05 (BridgePower Corp.)

· Extended power pack: DMPS034039-04/DMPS034039-06 (Daean Elecom Co., Ltd.)

– Используйте указанные выше модели адаптера и аккумуляторной батареи повышенной емкости.



- Do not remove the system's covers.

Внутри системы опасное для жизни высокое напряжение.

ВНИМАНИЕ




ЗАО «МЕДИЭЙС». Адрес: 127422, Россия,
г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3



Mie8 04, 18A
RUS 0510

Маркировка изделия

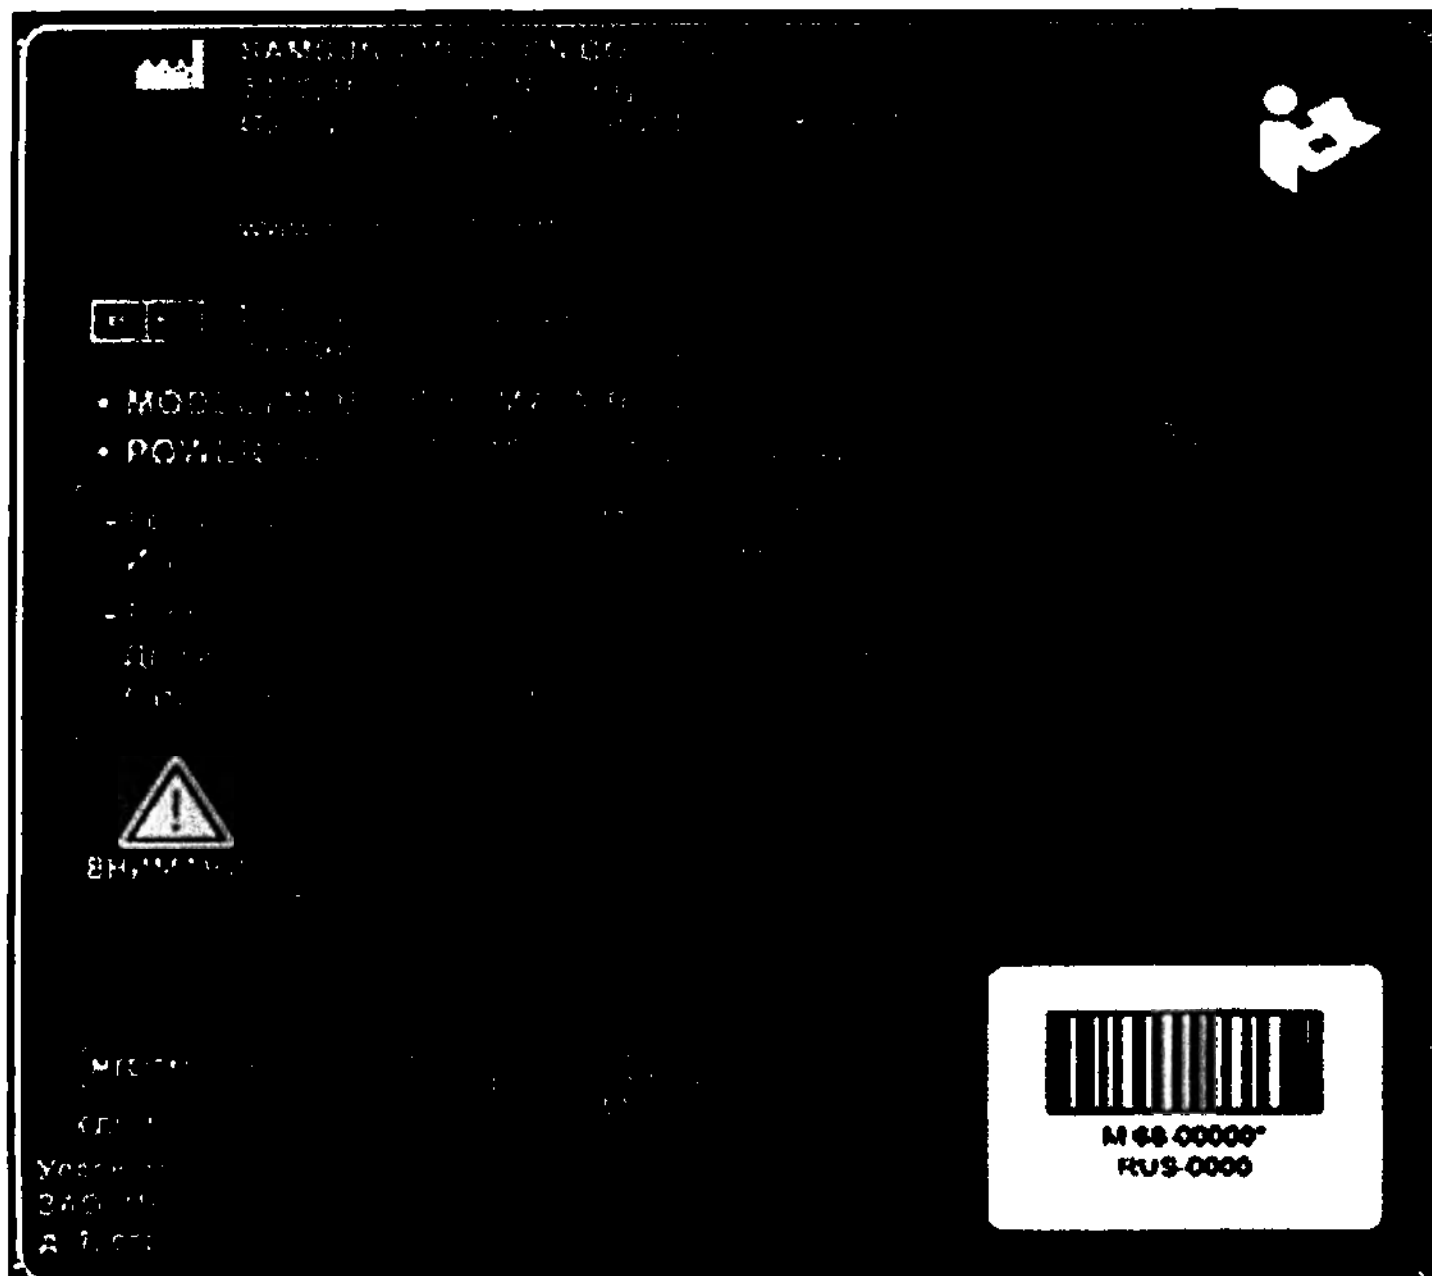

Маркировка изделия

Генеральный
директор
ЗАО "Медисис"
Викторов Н.В.



Пронумеровано и
прошнуровано 62 лист(ов)а