

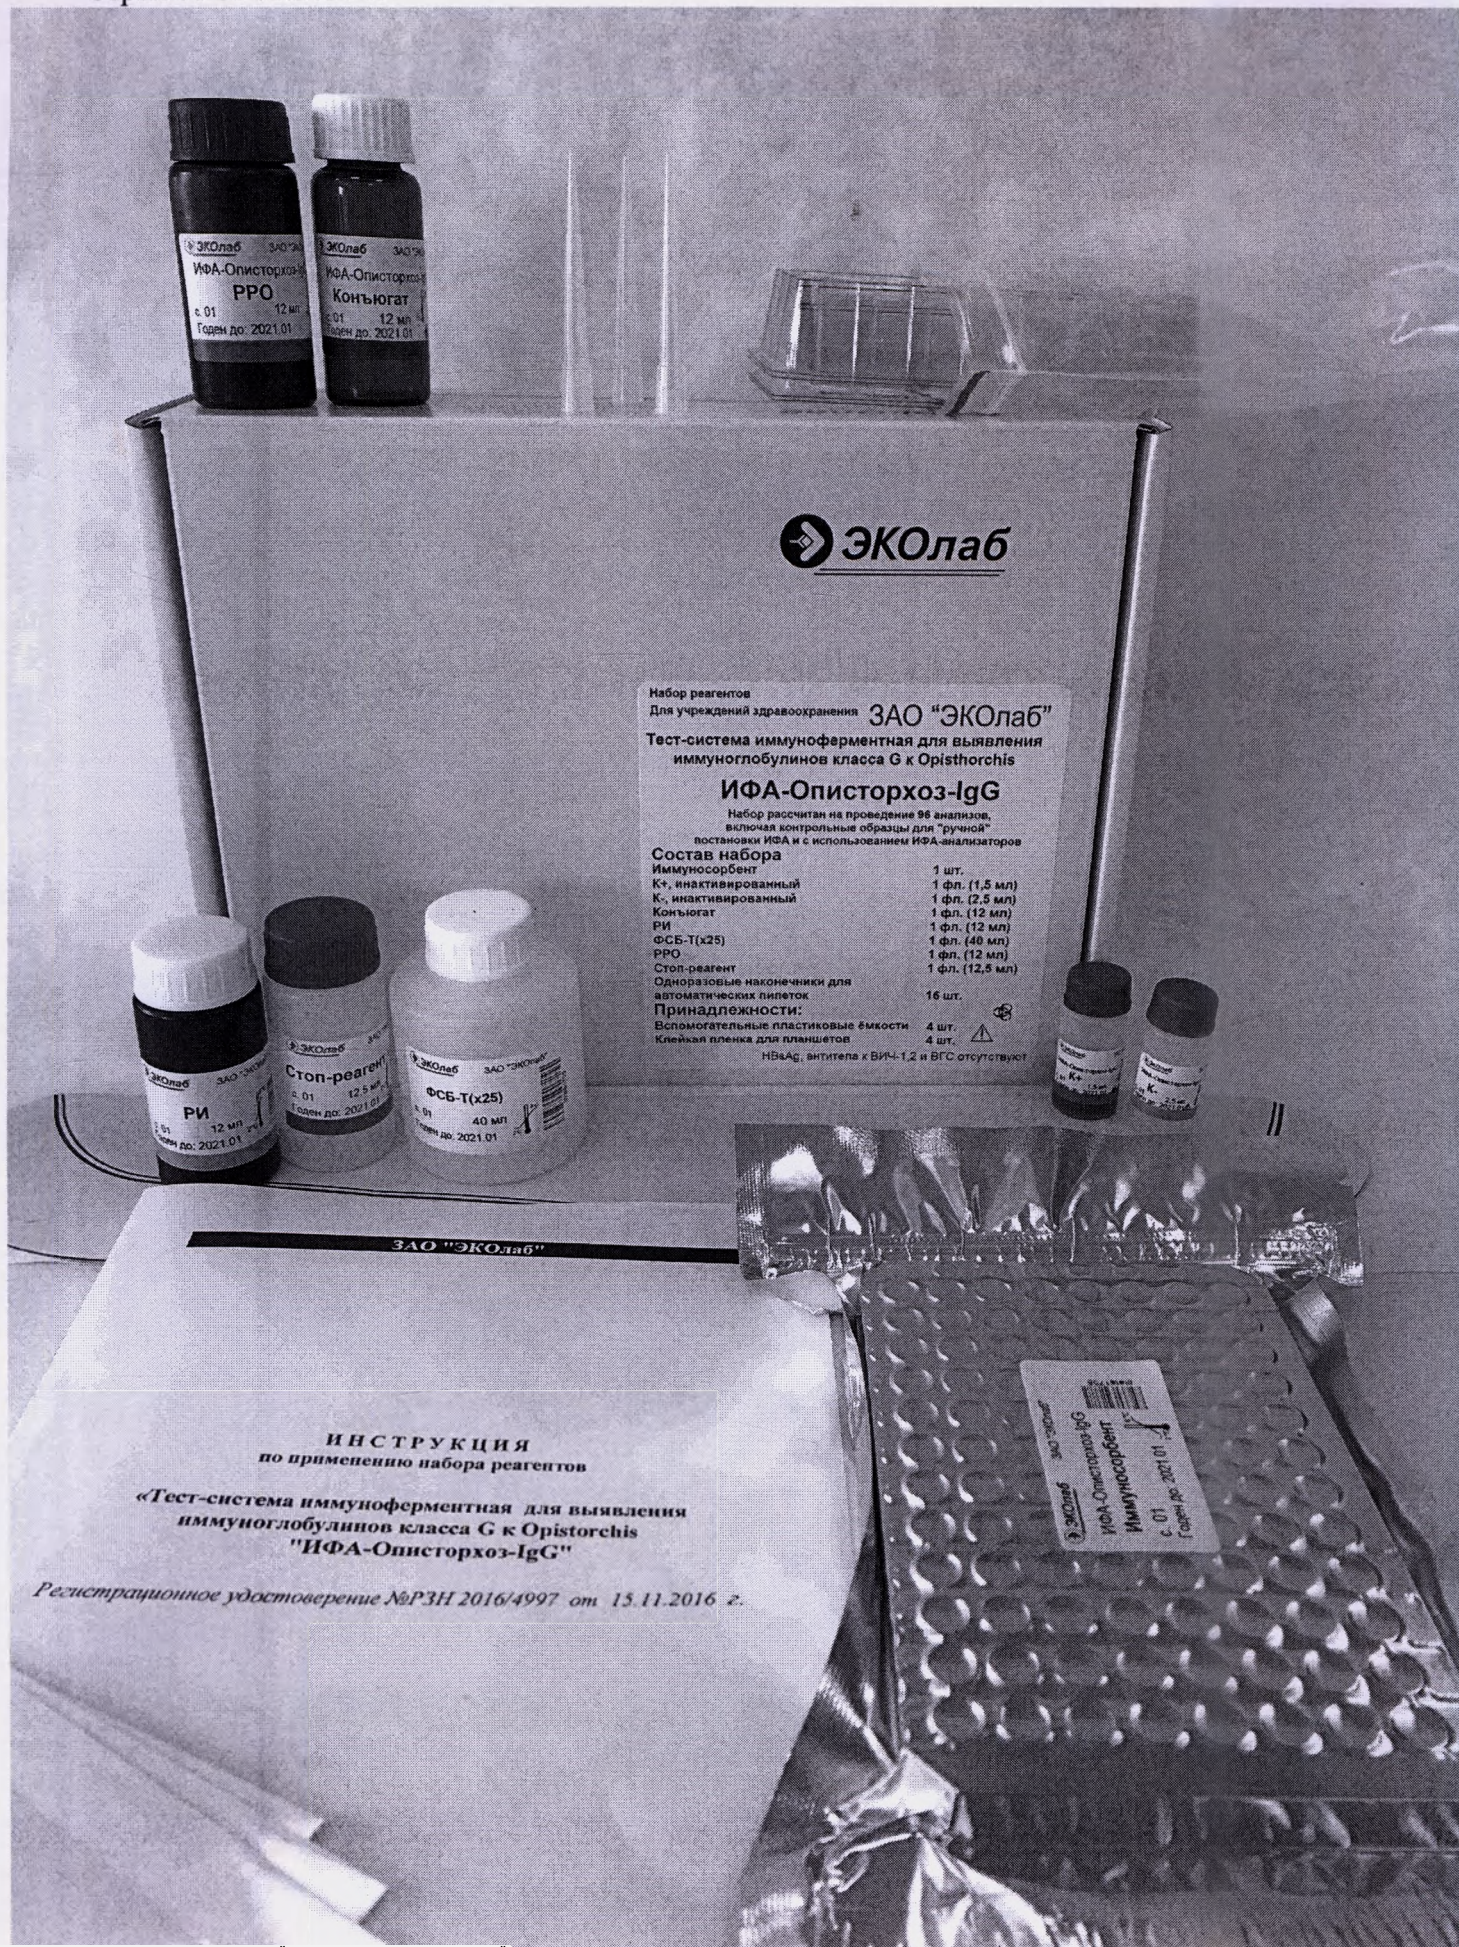


Фотографические изображения общего вида

Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам рода *Opisthorchis*» «ИФА-Описторхоз- IgG» с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

Серия 01 от 01.2020 г.





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения ЗАО «ЭКОлаб»
Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к Opisthorchis

ИФА-Описторхоз-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные образцы для "ручной"
поставки ИФА и с использованием ИФА-анализаторов


Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К-, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(х25)	1 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

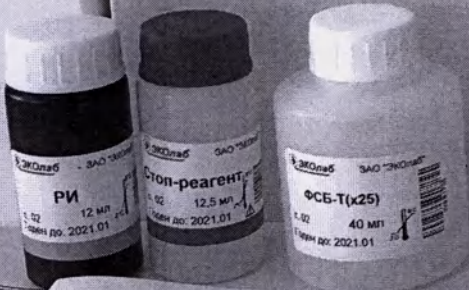

ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов

«Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к Opisthorchis
"ИФА-Описторхоз-IgG"»

Регистрационное удостоверение №РЗН 2016/4987 от 13.11.2016



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (984) лист а

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Борисов В.Ю.

"25" 12 2020 г.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к *Opisthorchis*

ИФА-Описторхоз-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные образцы для "ручной"
постановки ИФА и с использованием ИФА-анализаторов

Состав набора

Иммунсорбент

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

1 шт.

1 фл. (1,5 мл)

1 фл. (2,5 мл)

1 фл. (12 мл)

1 фл. (12 мл)

1 фл. (40 мл)

1 фл. (12 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

4 шт.

4 шт.

HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

2020 г



ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Описторхоз-IgG

ТУ 9398-174-70423725-2015, изм №1,2

РУ № РЗН 2016/4997 от 15.11.2016


Каталожный № 17.05

Серия 01

Контрольный № 74

Дата изготовления: 2020.01

Годен до: 2021.01



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

