




Фото набора реагентов


«Диагностикум для выявления антител класса G к *Toxoplasma gondii* в реакции иммунофлуоресценции» «Токсоплазма - Флюороген-IgG»

Комплект №1, серия 01 от 08.2014 г.

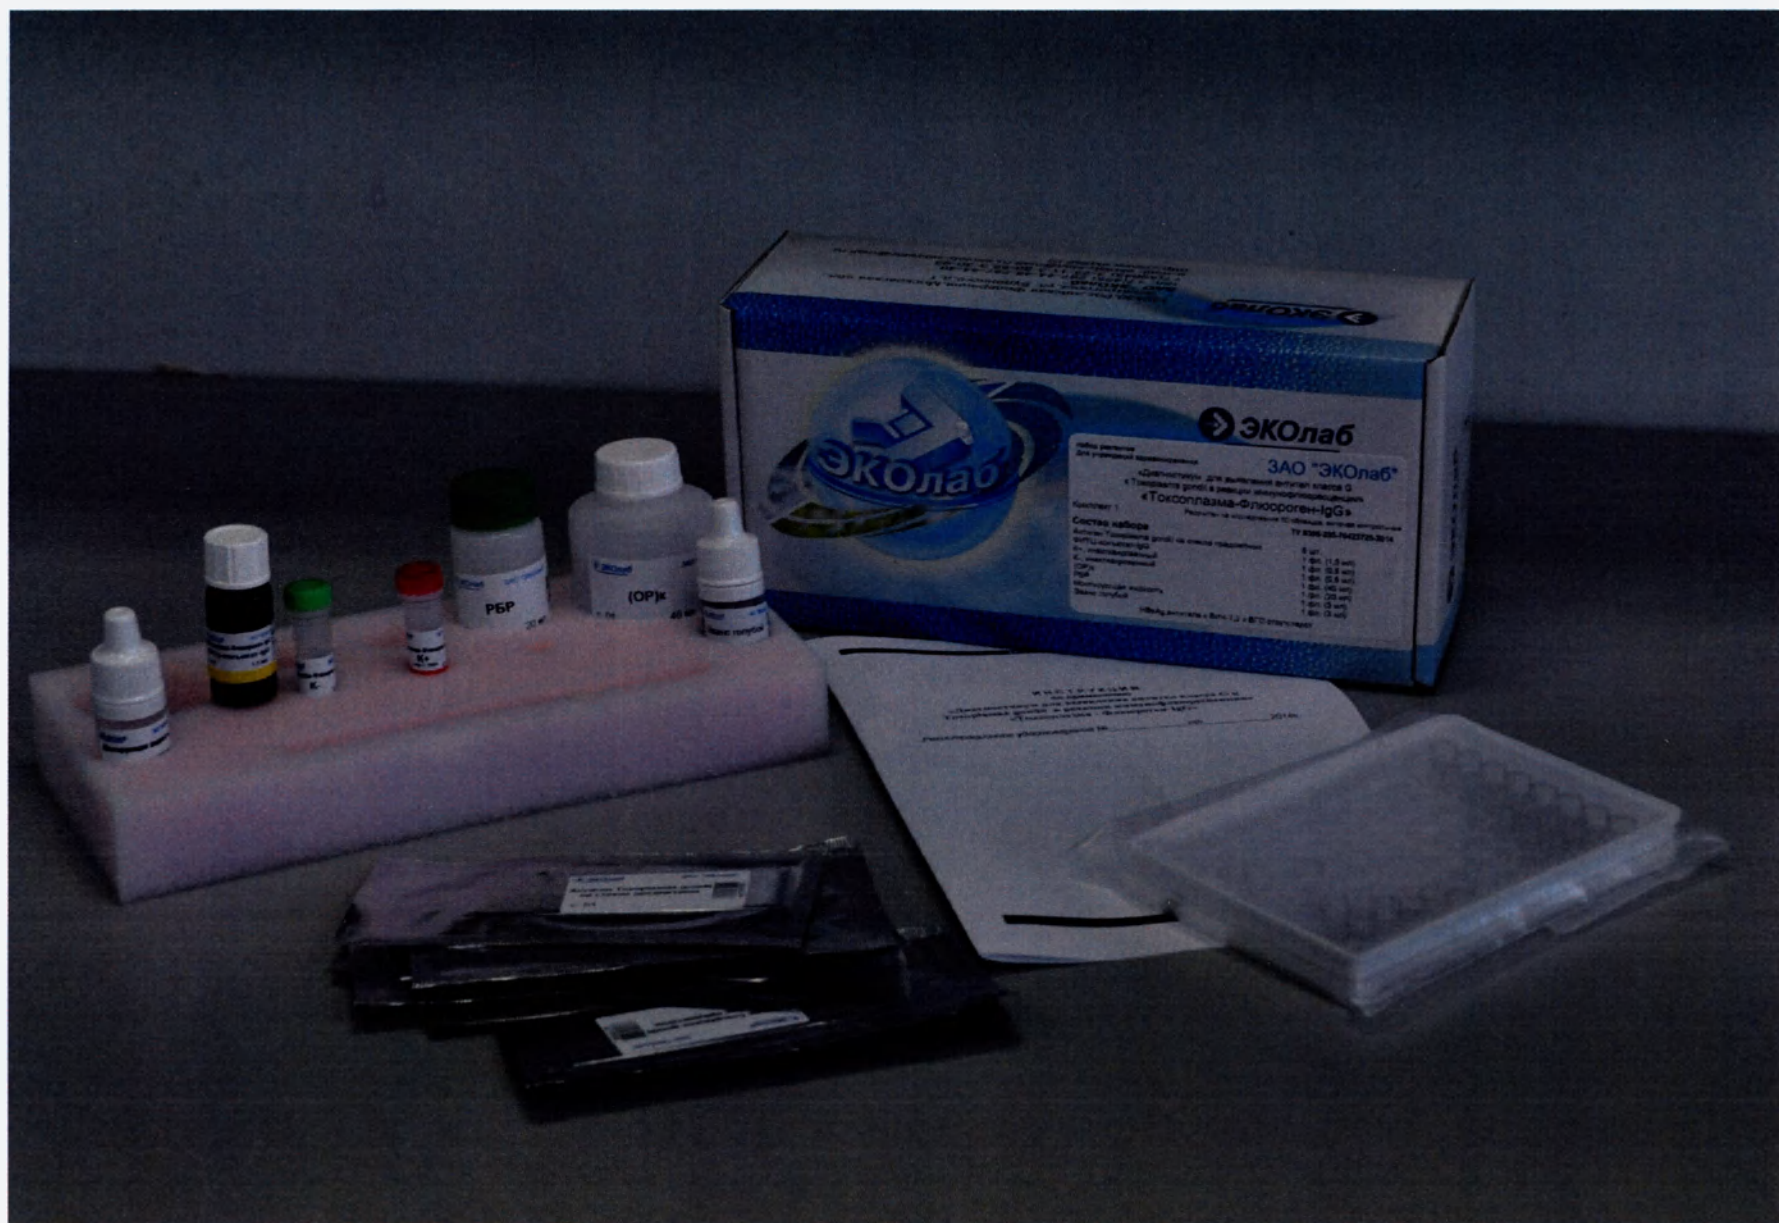

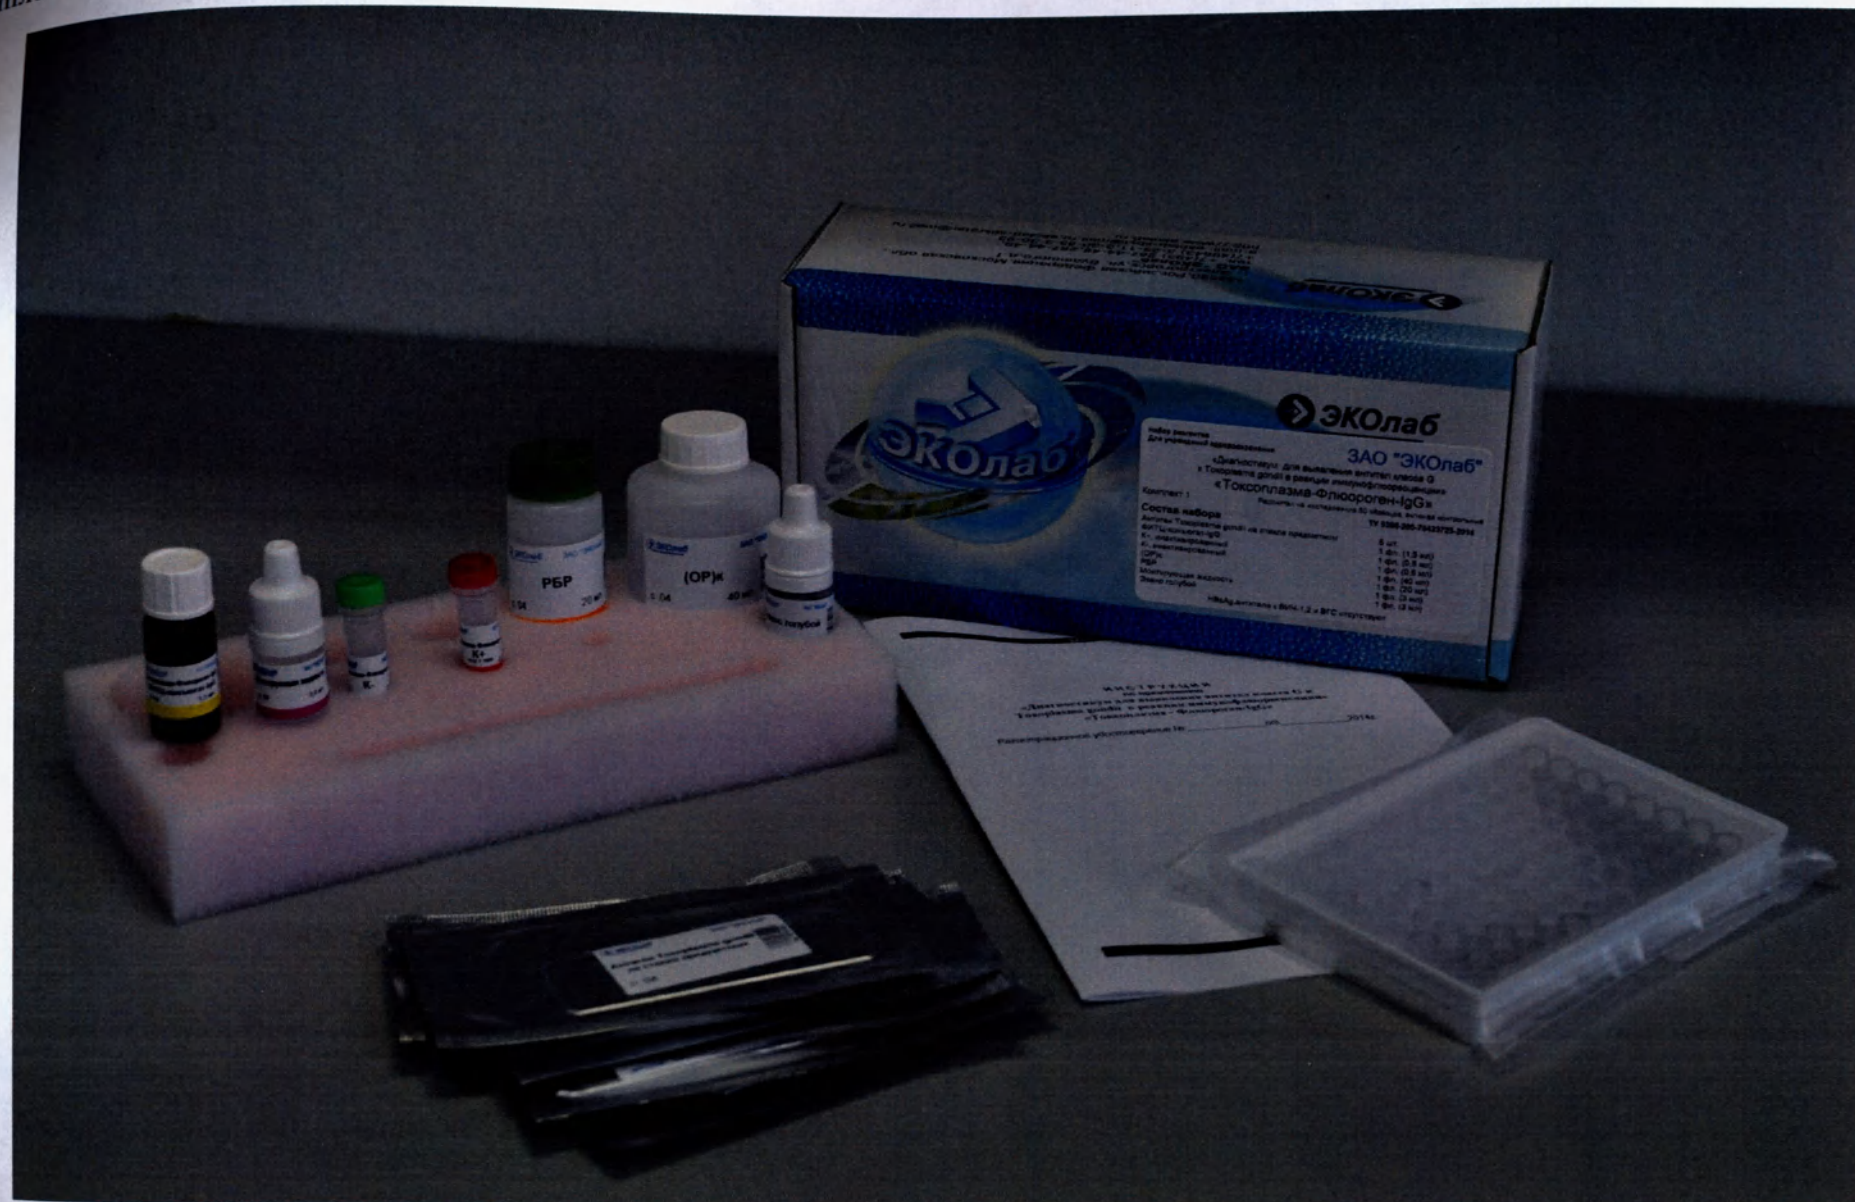

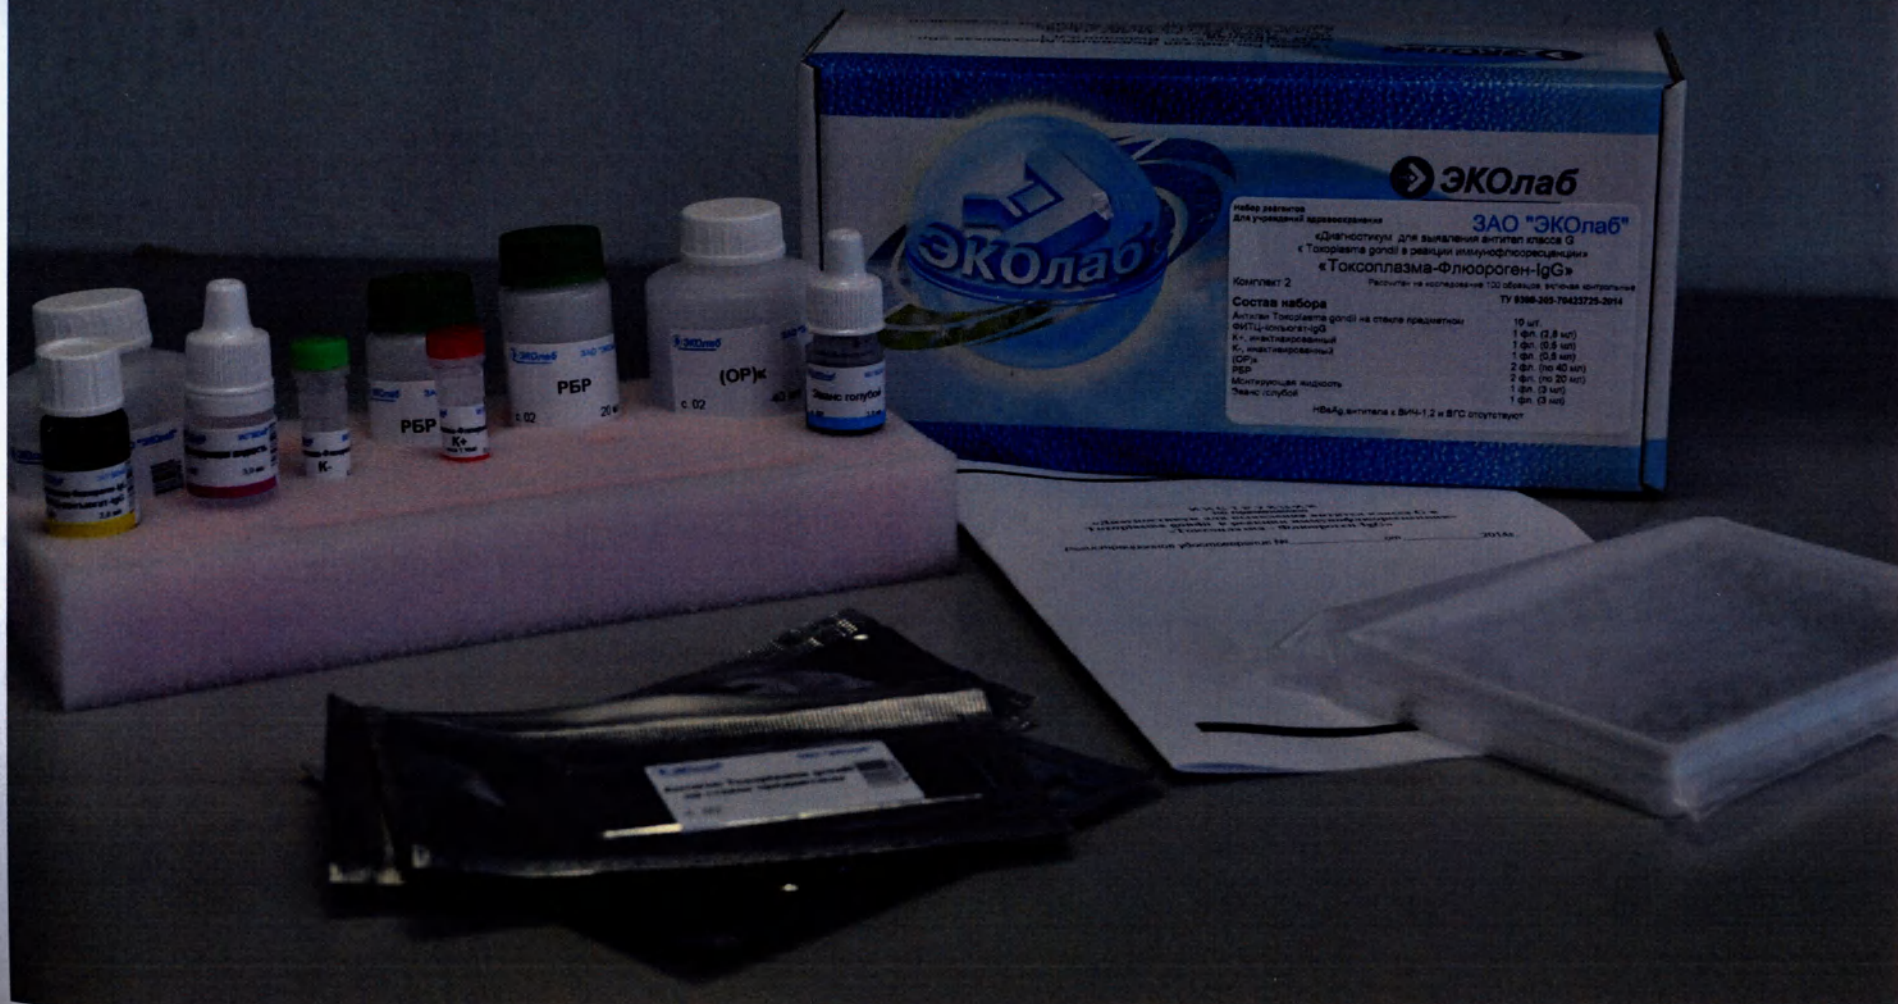

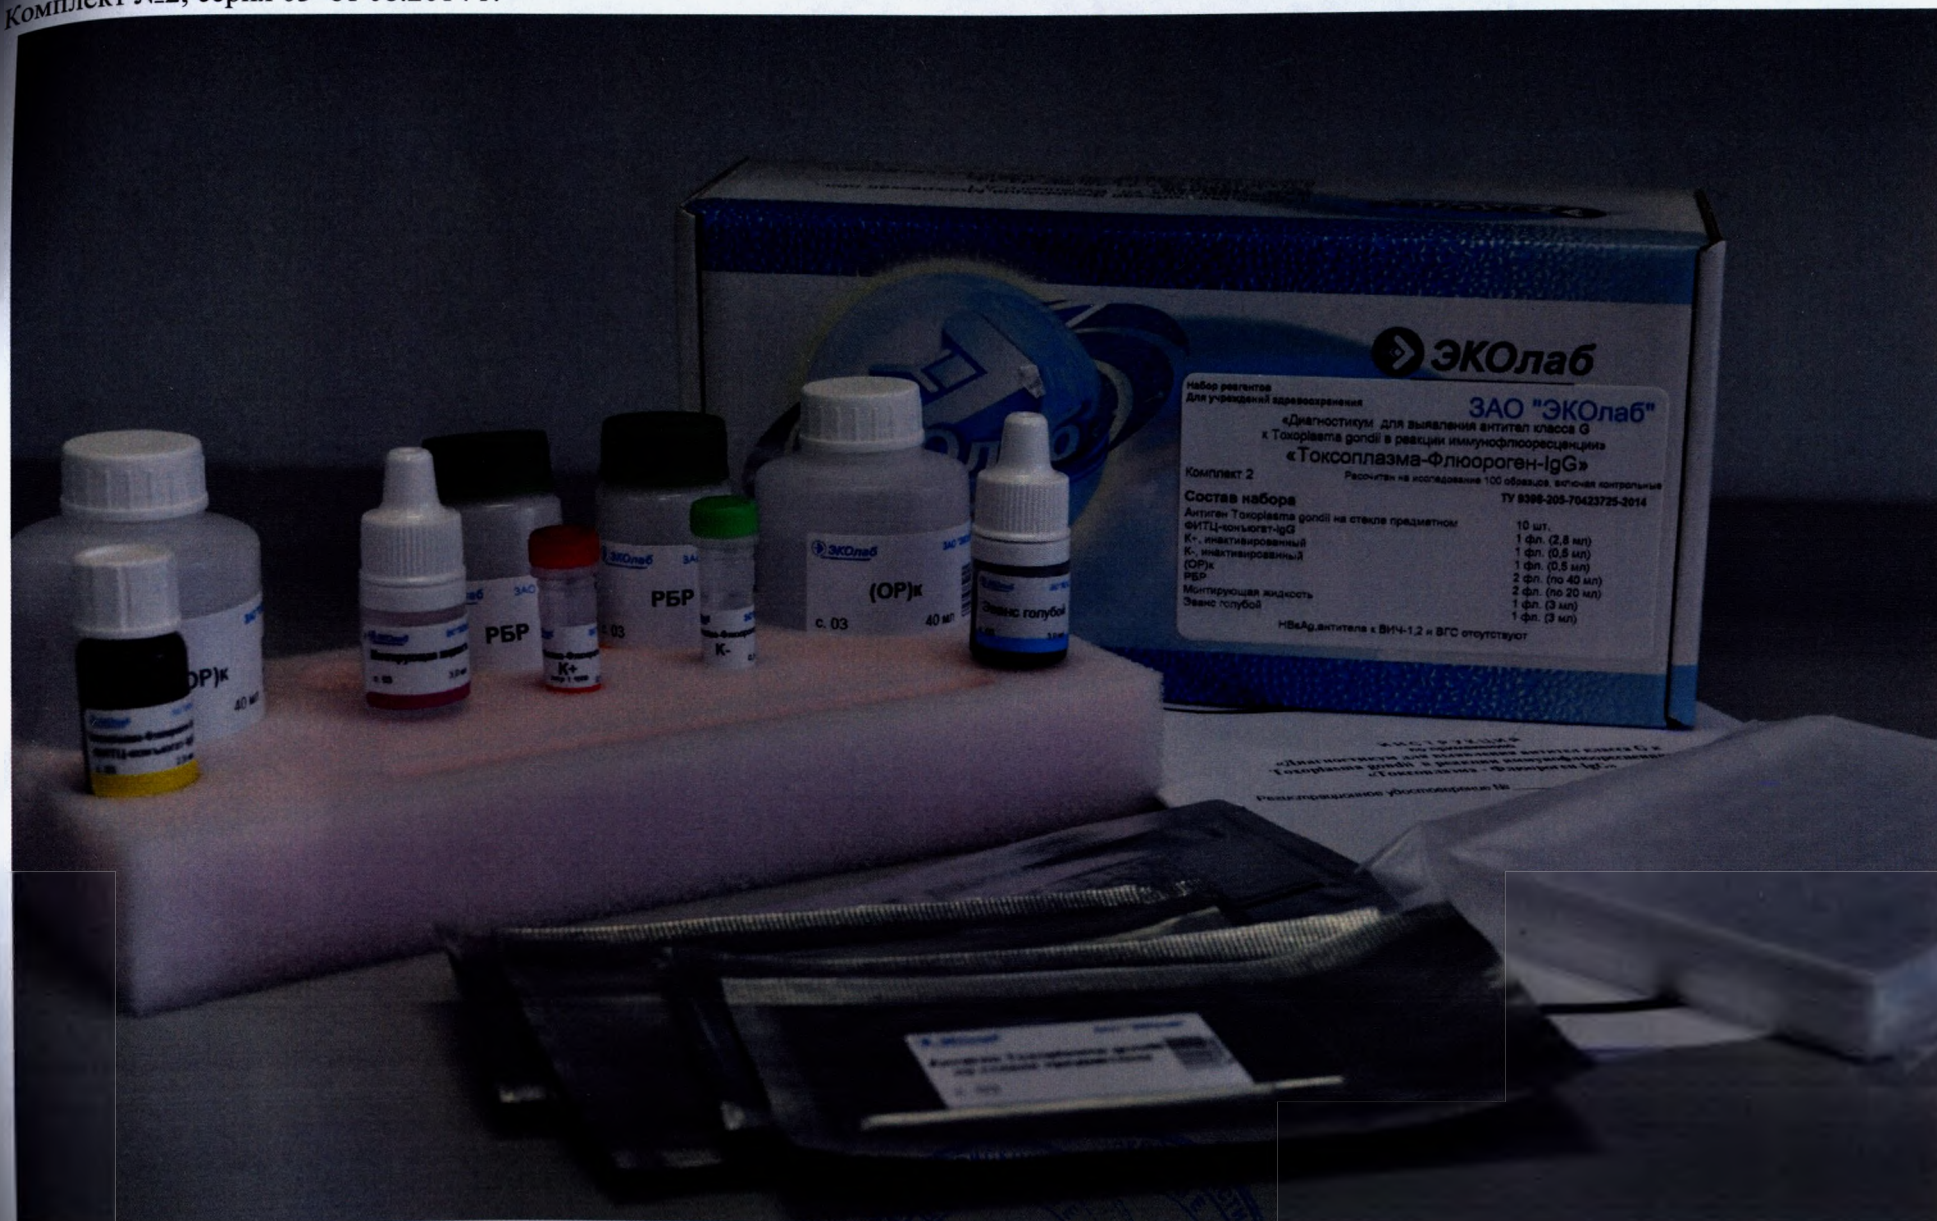

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"06" февраля 2015 г.